



Морозильник медицинский ММШ-220 «POZIS».
Общий вид

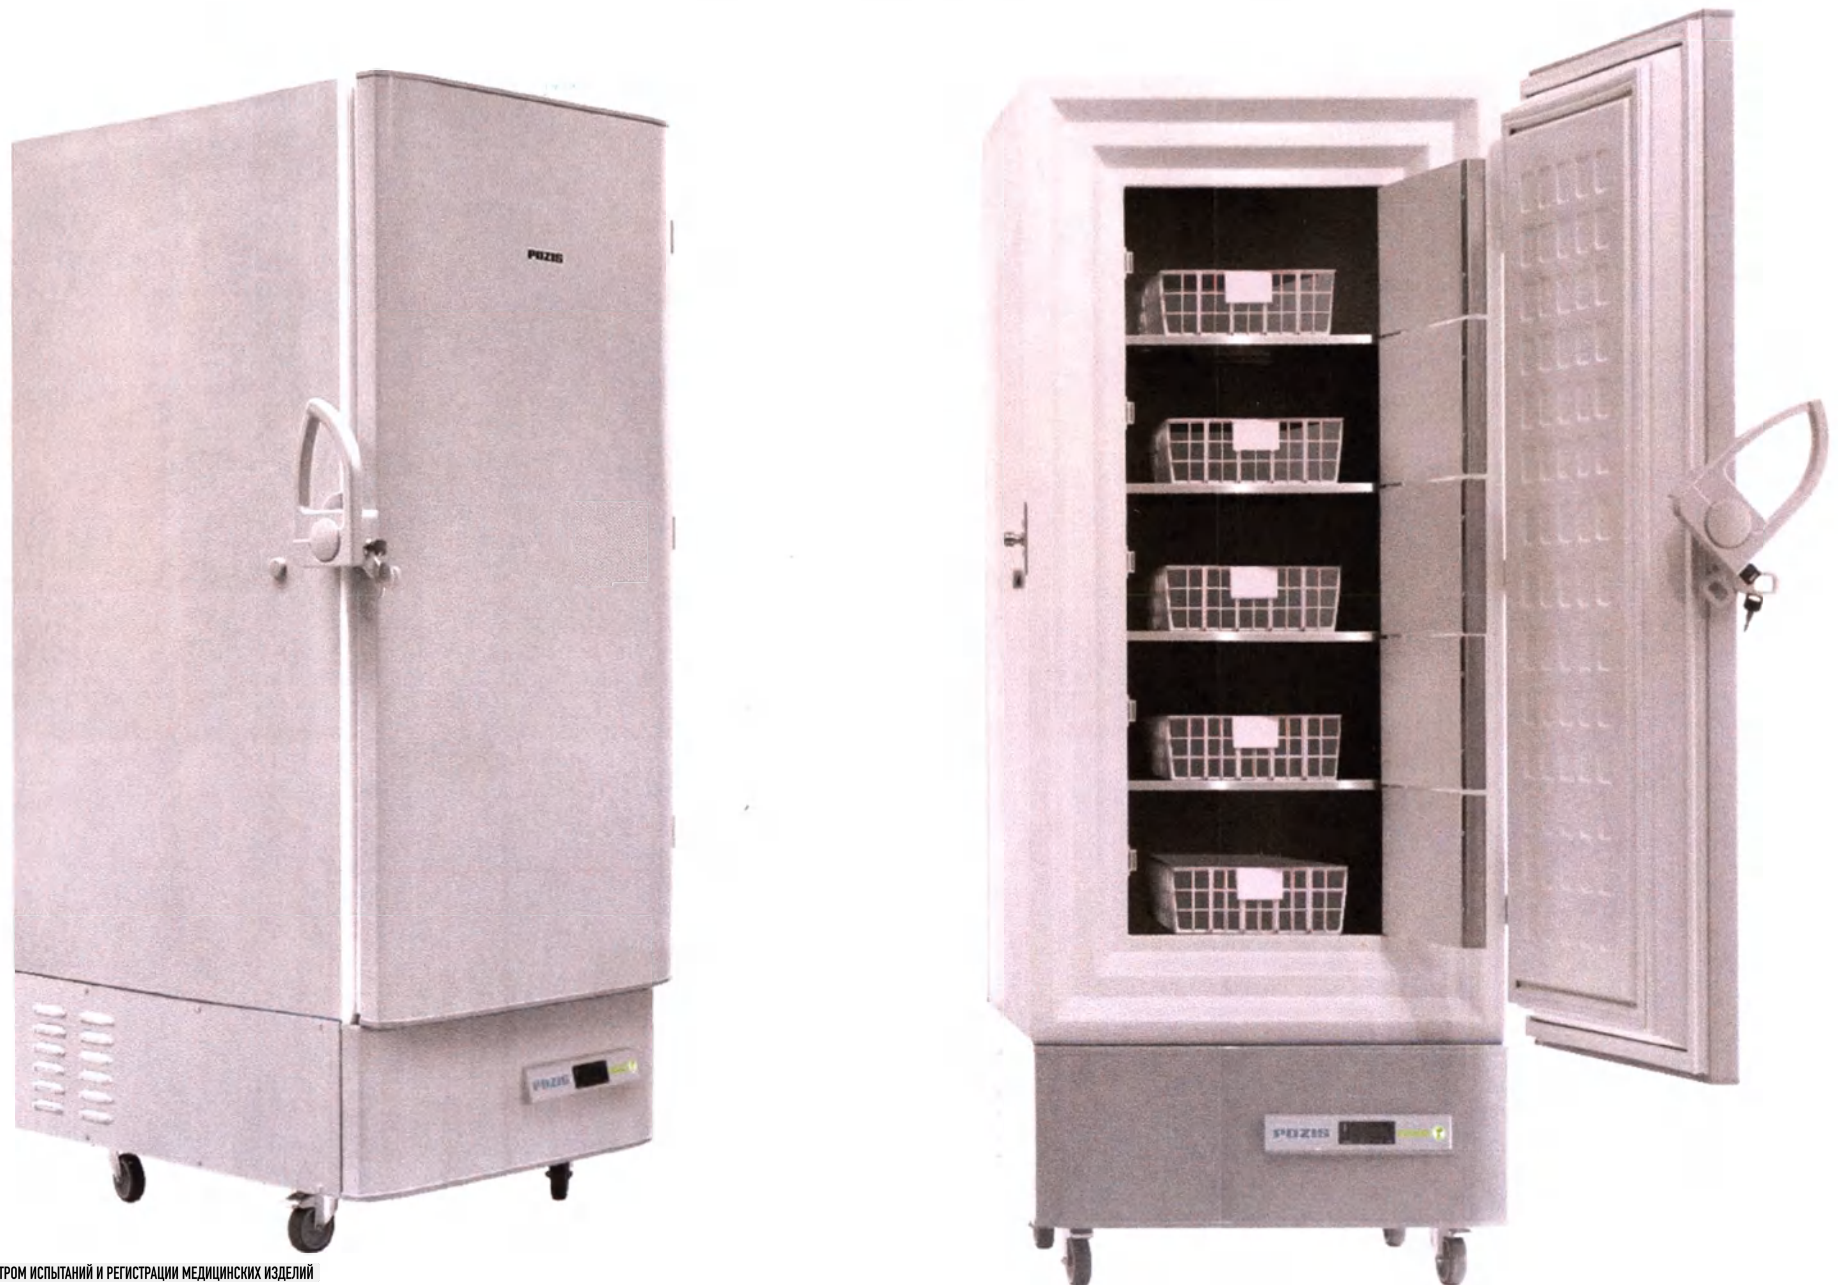


Морозильник медицинский ММШ-220 «POZIS».
Варианты блока управления

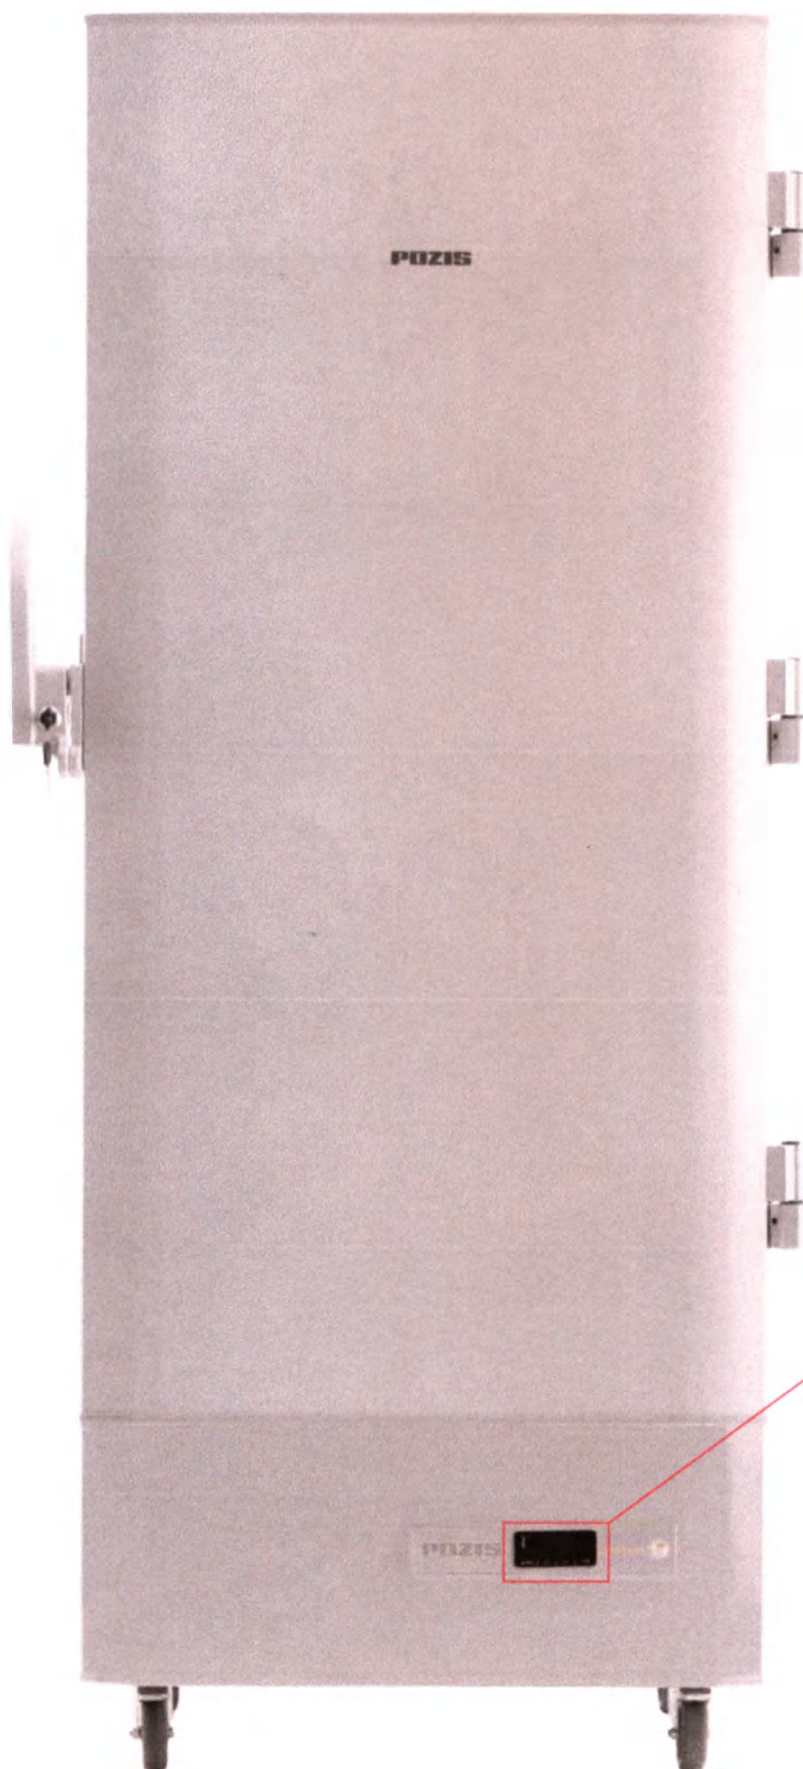

Блок управления
ESC-2180neo
фирмы JIANGSU
JINGCHUANG
ELECTRONICS
CO.,LTD, Китай

Морозильник медицинский ММШ-220 «POZIS».


Варианты блока управления

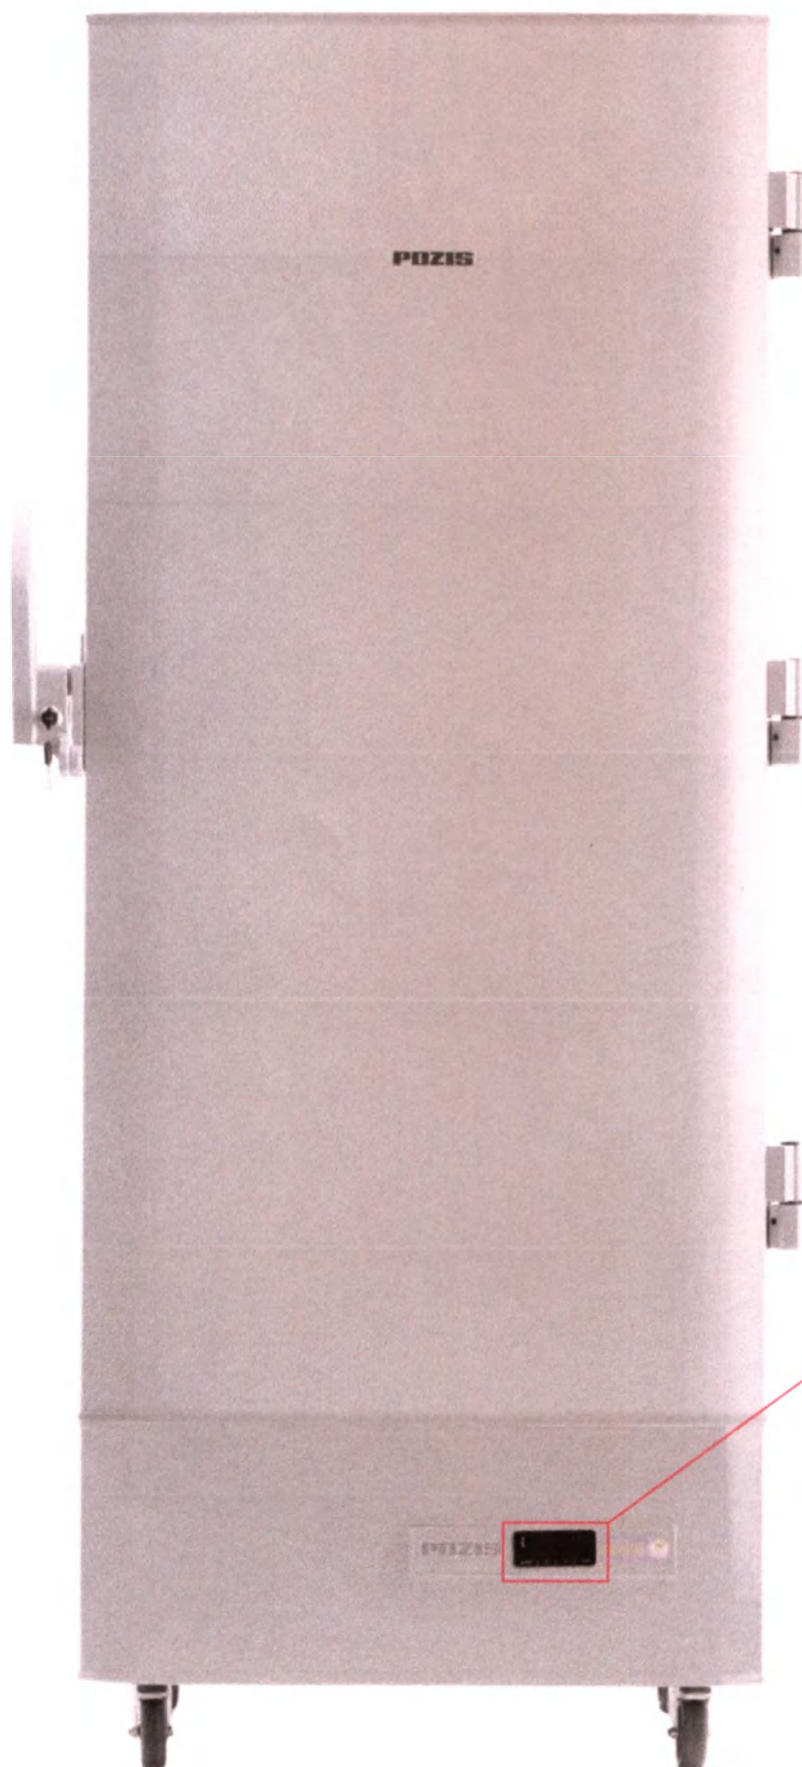

Блок управления
EV3B22P7VXRB
фирмы EVCO SPA,
Италия

Морозильник медицинский ММШ-220 «POZIS».


Варианты блока управления

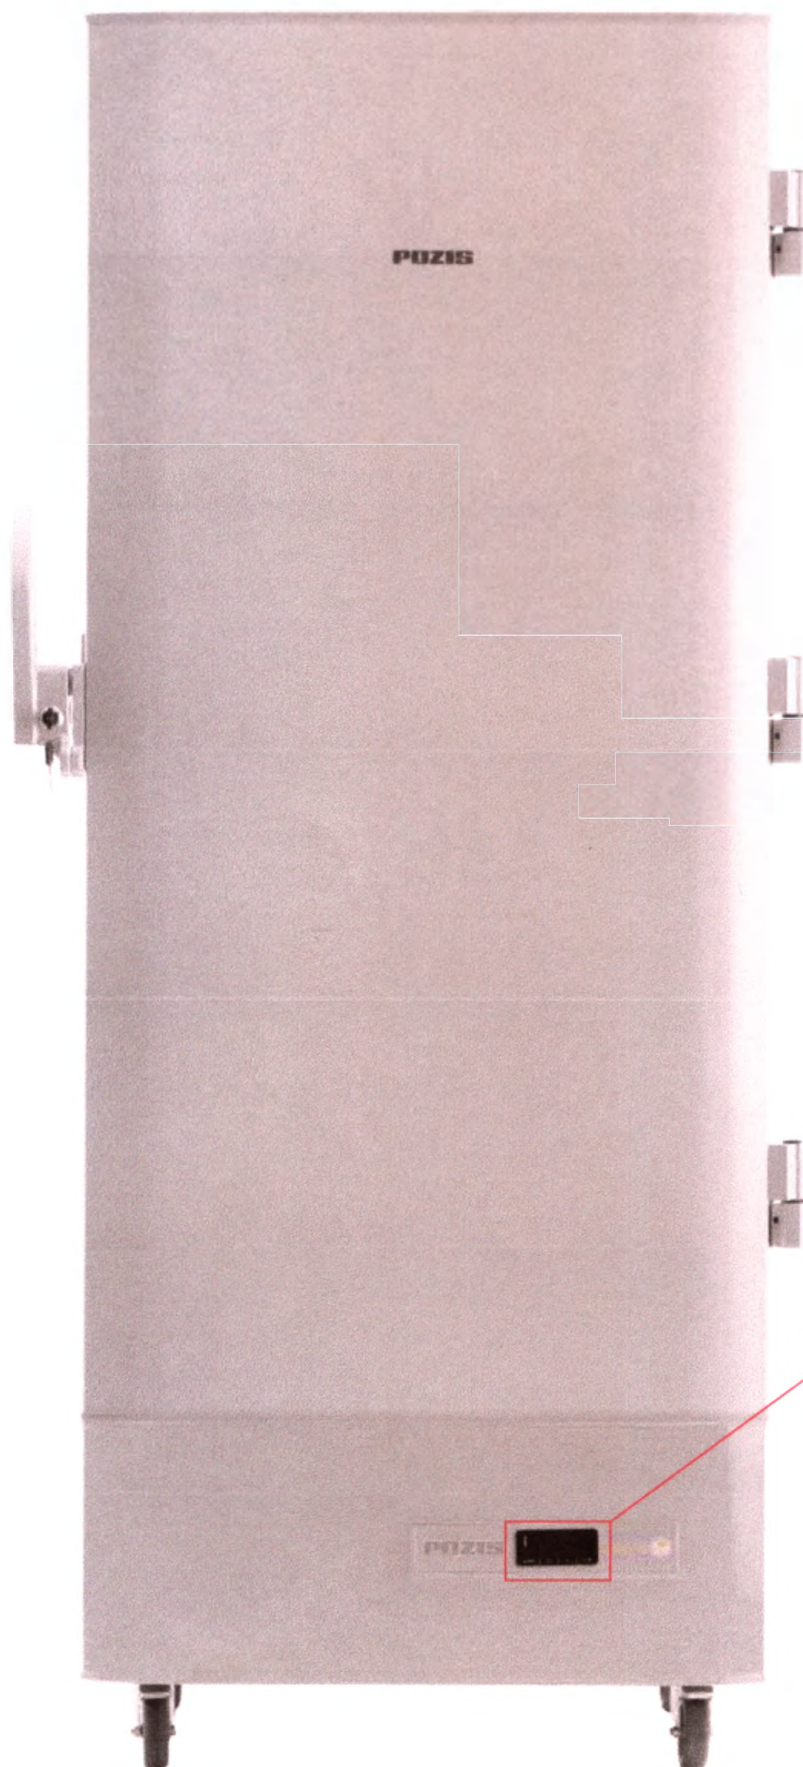

Блок управления
КТ-01
АО ПО «УОМЗ»

Морозильник медицинский ММШ-220 «POZIS».


Варианты блока управления

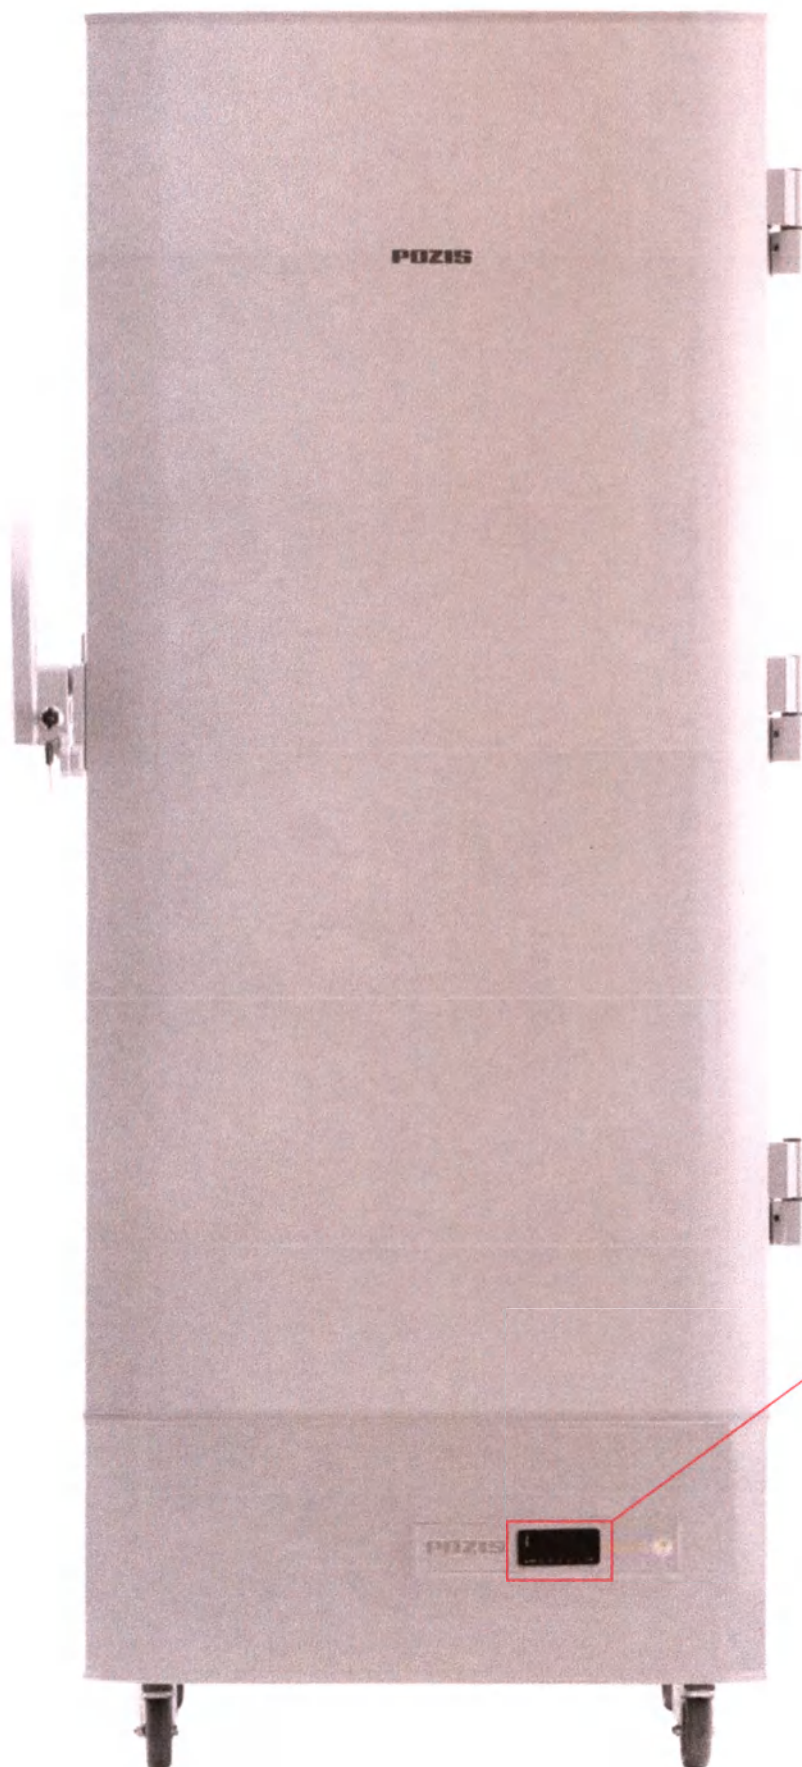

Блок управления
с – prom.m1
ООО «ПРОМЭНЕР-
ГО»

Морозильник медицинский ММШ-220 «POZIS».


Варианты блока управления

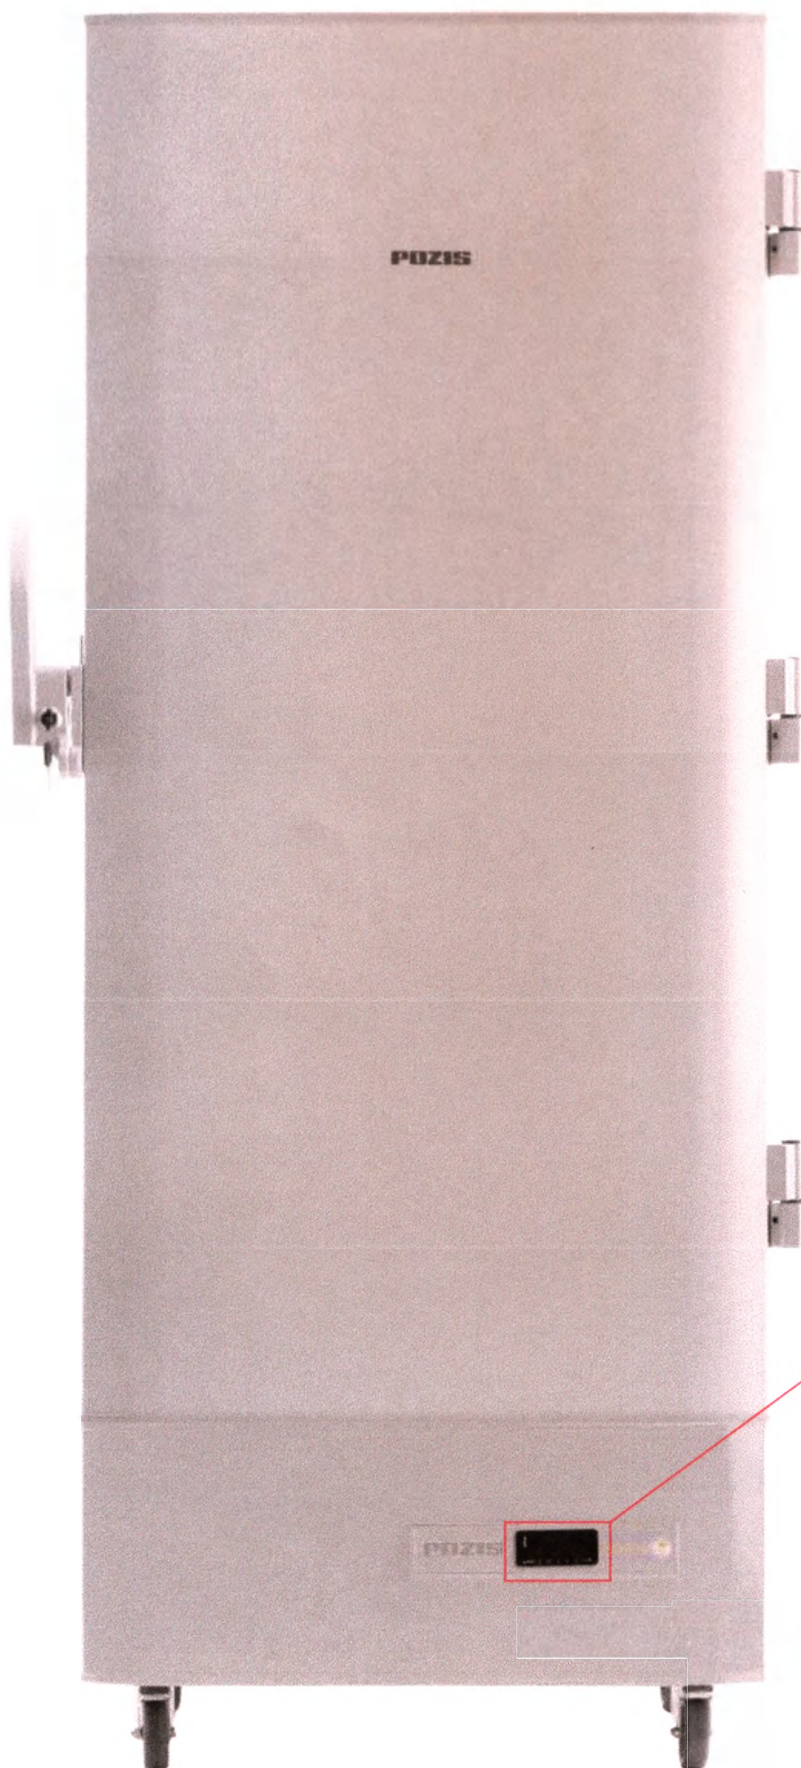


Блок управления
ERC112C
ООО «Данфосс»

Морозильник медицинский ММШ-220 «POZIS».

Варианты блока управления

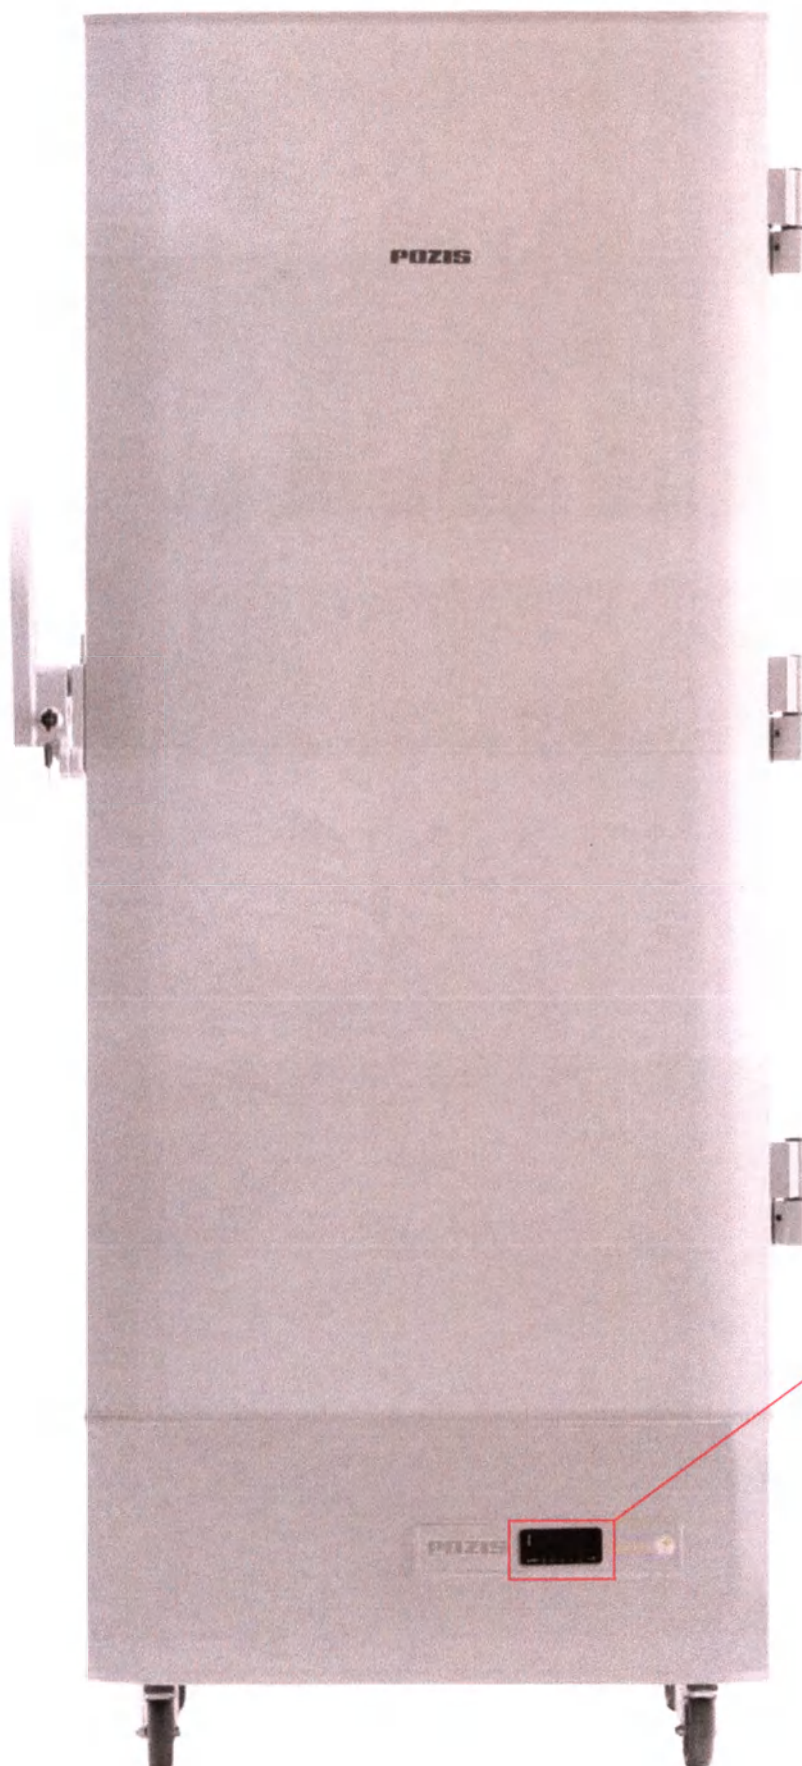

Блок управления
БУ-M02
ООО «Мир»

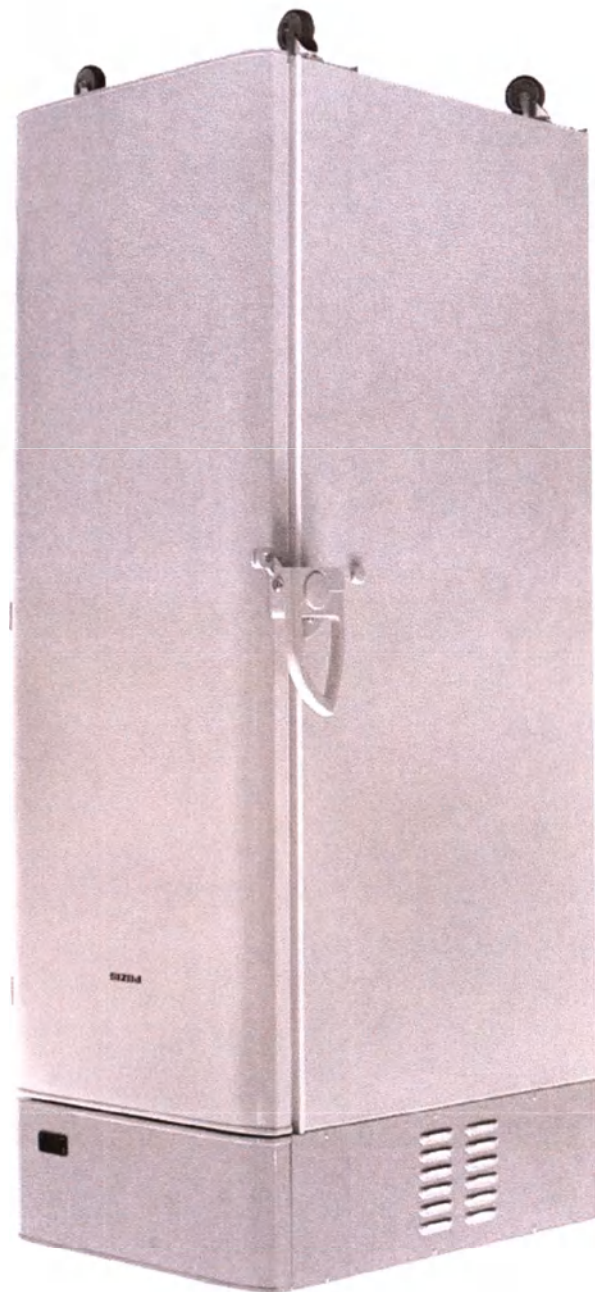


Общий вид.

Морозильник медпунктский ММШ-350 «POLIS».

Морозильник медицинский ММШ-350 «POZIS».


Варианты блока управления

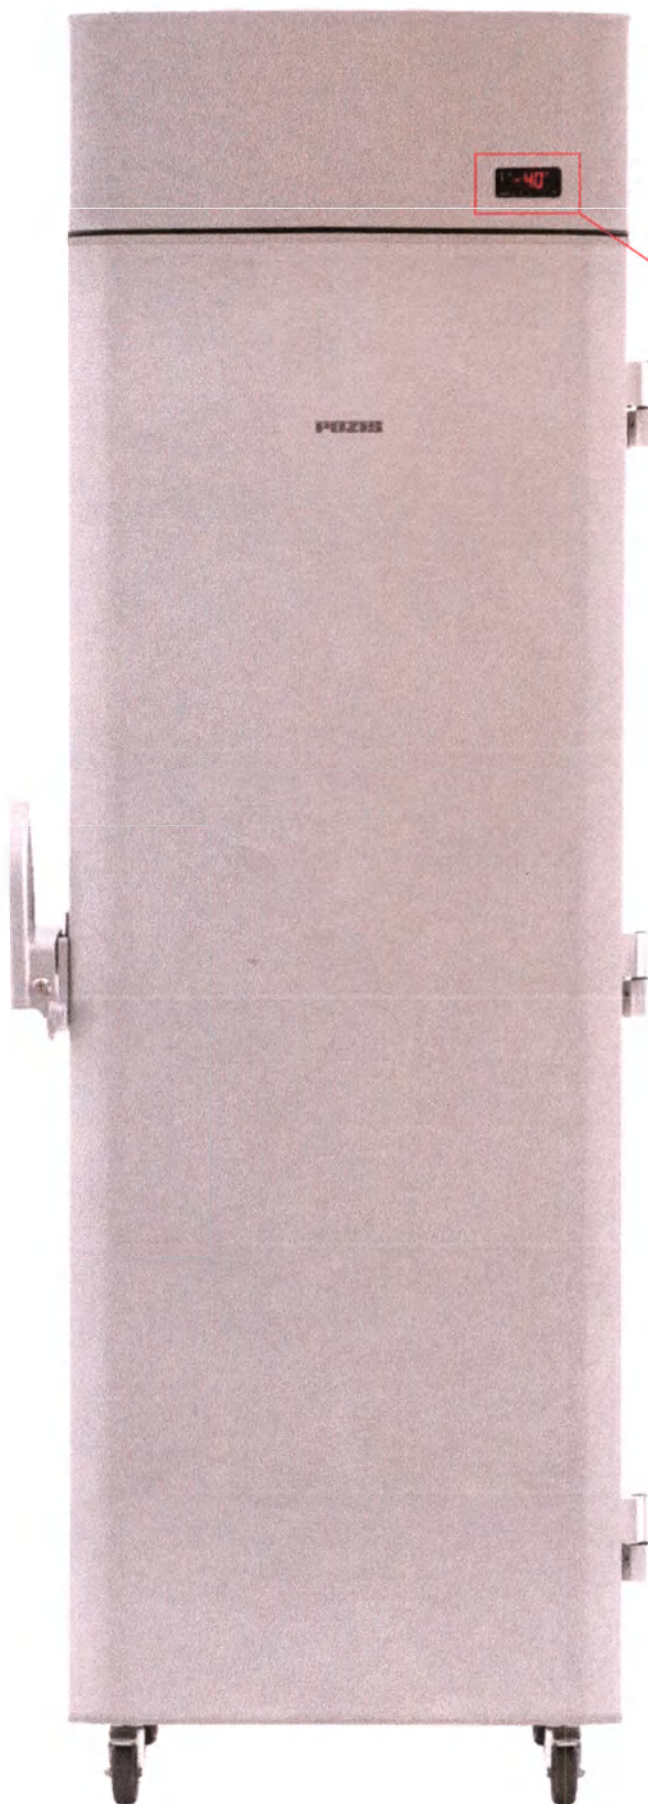

Блок управления
ESC-2180neo
фирмы JIANGSU
JINGCHUANG
ELECTRONICS
CO.,LTD, Китай

Морозильник медицинский ММШ-350 «POZIS».


Варианты блока управления

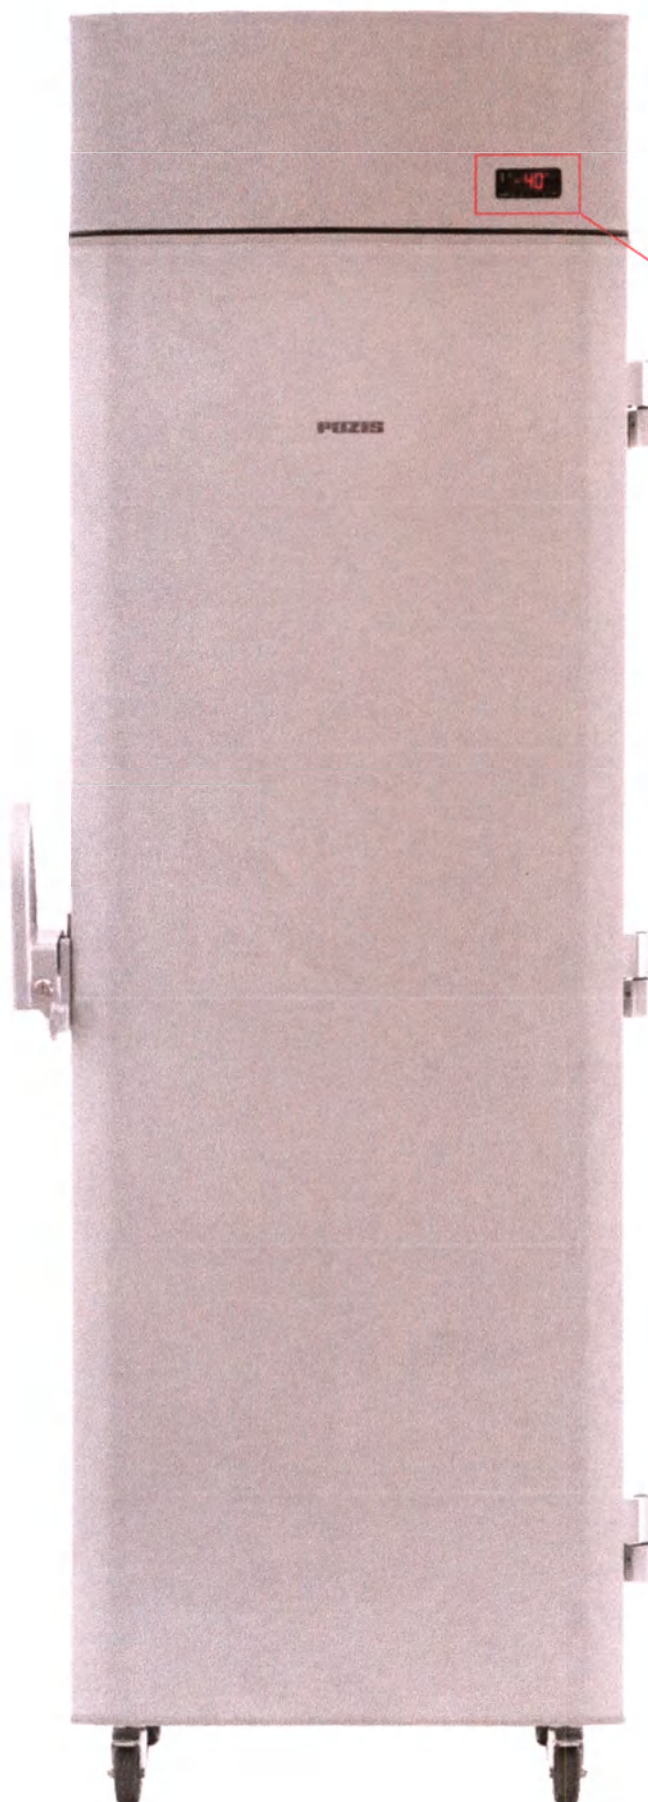

Блок управления
EV3B22P7VXRB
фирмы EVCO SPA,
Италия

Морозильник медицинский ММШ-350 «POZIS».


Варианты блока управления

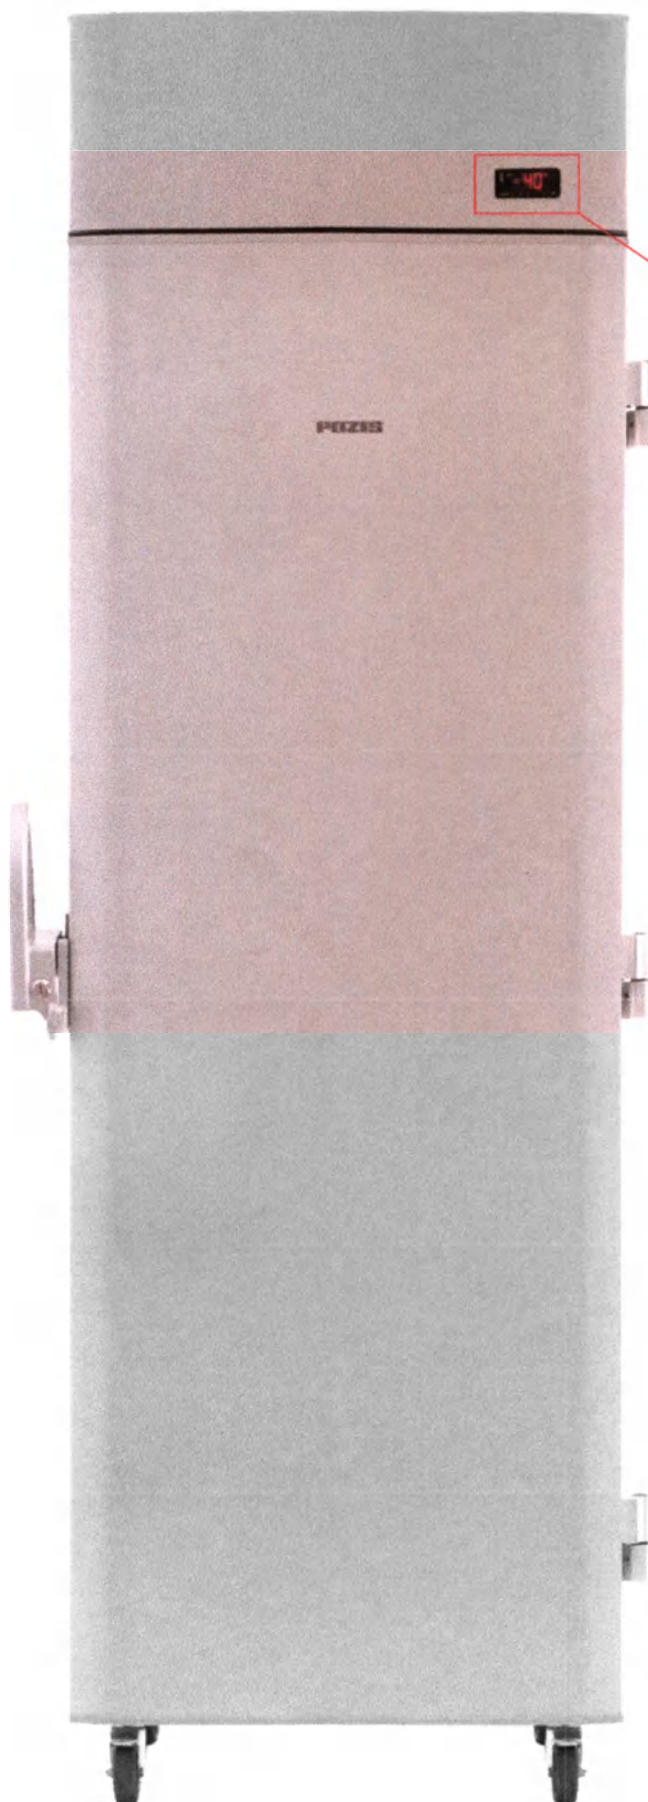

Блок управления
КТ-01
АО ПО «УОМЗ»

Морозильник медицинский ММШ-350 «POZIS».


Варианты блока управления

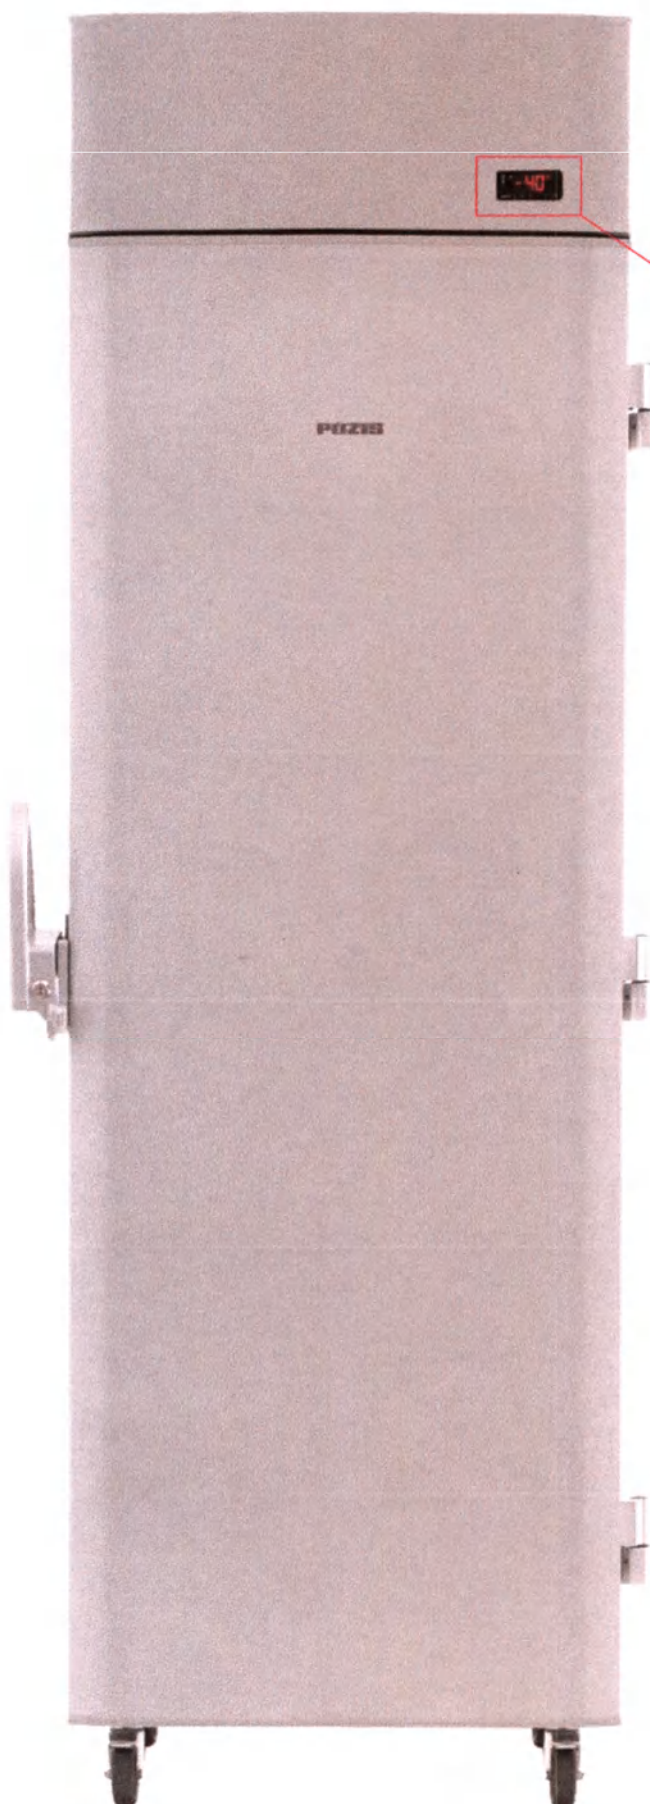

Блок управления
с – prom.m1
ООО «ПРОМЭНЕР-
ГО»

Морозильник медицинский ММШ-350 «POZIS».


Варианты блока управления

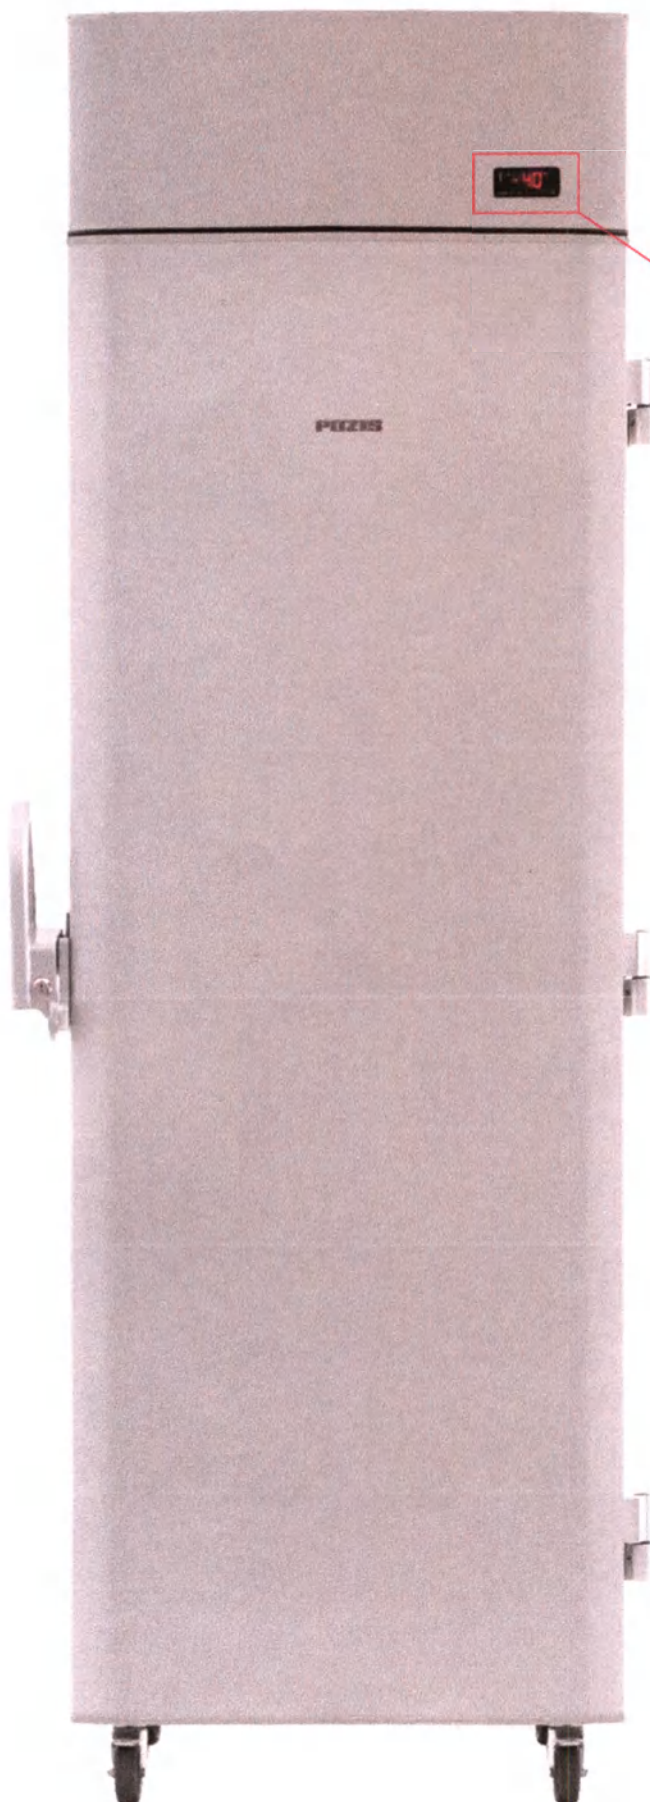

Блок управления
ERC112C
ООО «Данфосс»

Морозильник медицинский ММШ-350 «POZIS».

Варианты блока управления

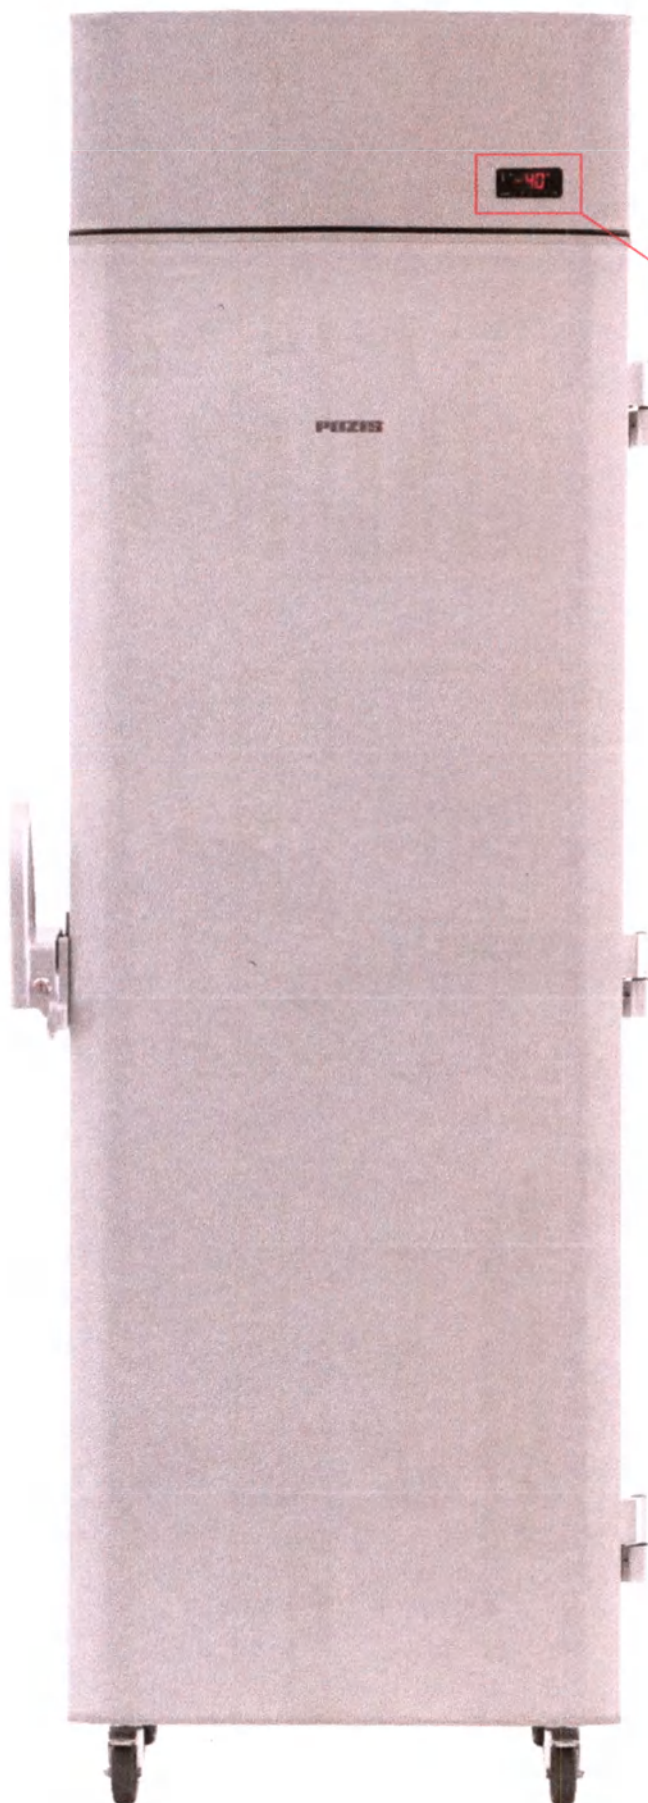

Блок управления
БУ-M02
ООО «Мир»

Морозильники медицинские ММШ-220 «POZIS», ММШ-350 «POZIS»

Макет маркировки морозильников медицинских

Ярлык упаковки:

POZIS		CE	
прикреплять код этикетки к корпусу изделия автоматической идентификационной системой EAN 13			
МОРОЗИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ ММШ- «POZIS»			
ТУ 9452-195-07503307-2008 СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ:		230В ~ 50Гц 10 лет	
 высота ширина глубина СДЕЛАНО В РОССИИ	БРУТТО кг		
ДАТА ВЫПУСКА	20 г.		
		ММШ- «POZIS» XXXXXXXXXXXX переносный номер по системе маркировки продукции-идентификации	

Табличка холодильника:


POZIS	МОРОЗИЛЬНИК МЕДИЦИНСКИЙ		
ММШ- 	серия модели морозильника	«POZIS»	IP20
ТУ 9452-195-07503307-2008	УХЛ 4,2		
R 404a	допол. зарядки	±0,5г	
 Вт	230В ~ 50Гц		
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	10 лет		
РЕЖИМ РАБОТЫ	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ		
СДЕЛАНО В РОССИИ			CE
№ 	серийный номер изделия	даты выпуска	20 г.

Морозильники медицинские ММШ-220 «POZIS», ММШ-350 «POZIS»
Фотообразец маркировки.


Ярлык упаковки:



Табличка холодильника:

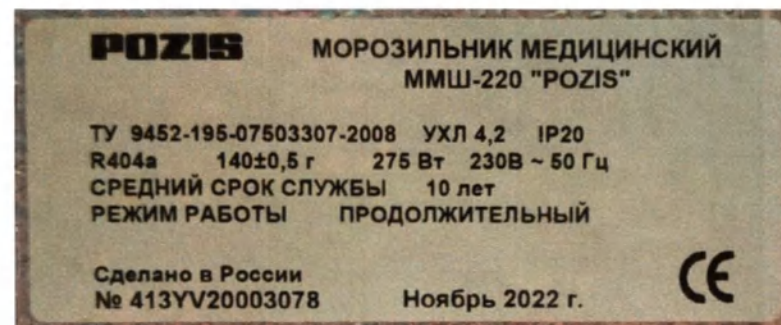

Морозильник медицинский ММШ-220 «POZIS» Оригинал-макет упаковки.

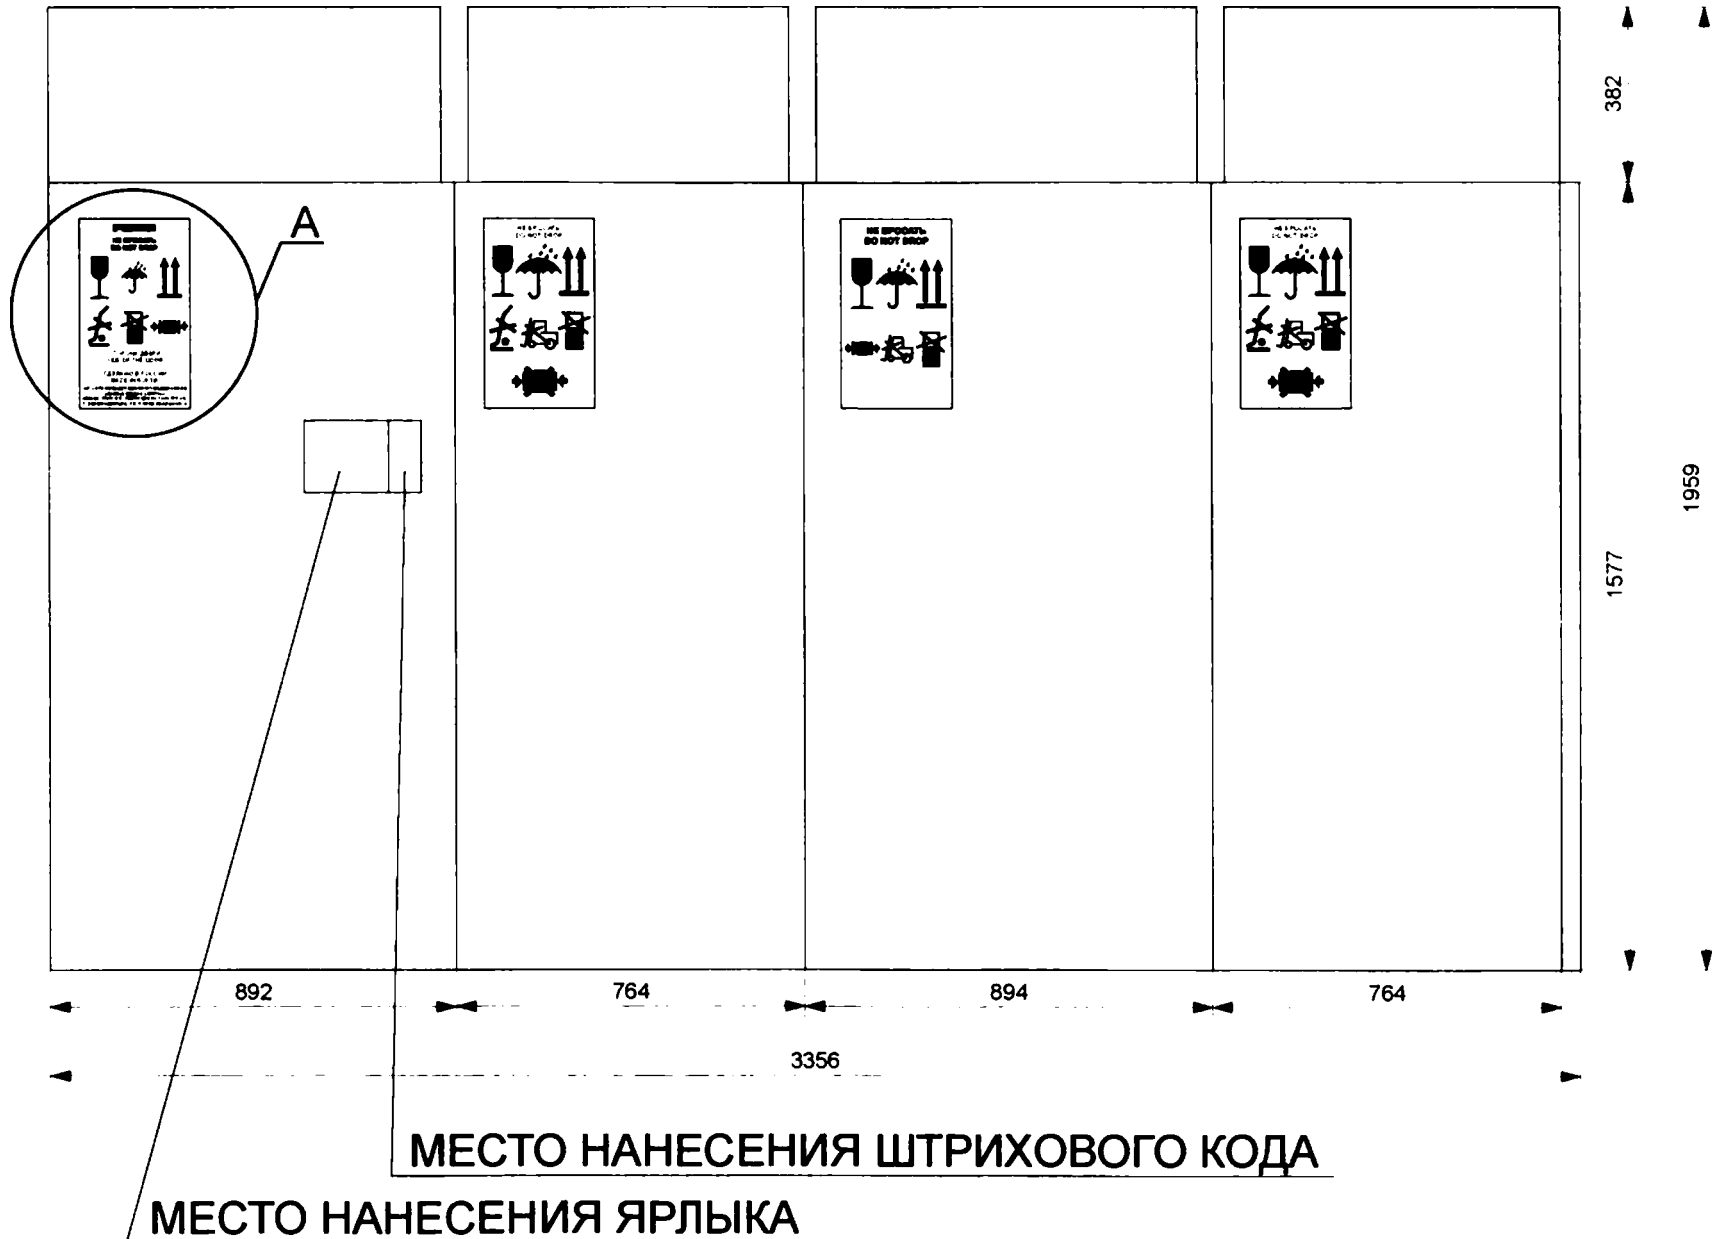


Морозильники медицинские ММШ-350 «POZIS» Оригинал-макет упаковки.

ВИД А

POZIS


НЕ БРОСАТЬ
DO NOT DROP

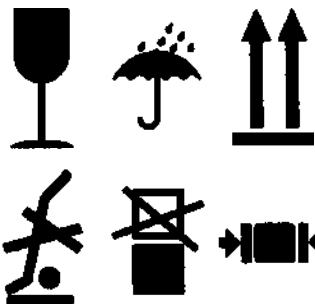

СТОРОНА ДВЕРИ
SIDE OF THE DOOR

СДЕЛАНО В РОССИИ
MADE IN RUSSIA

АО «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО»»
422546, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,
Г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, УЛ. ПРИВОКЗАЛЬНАЯ, 4

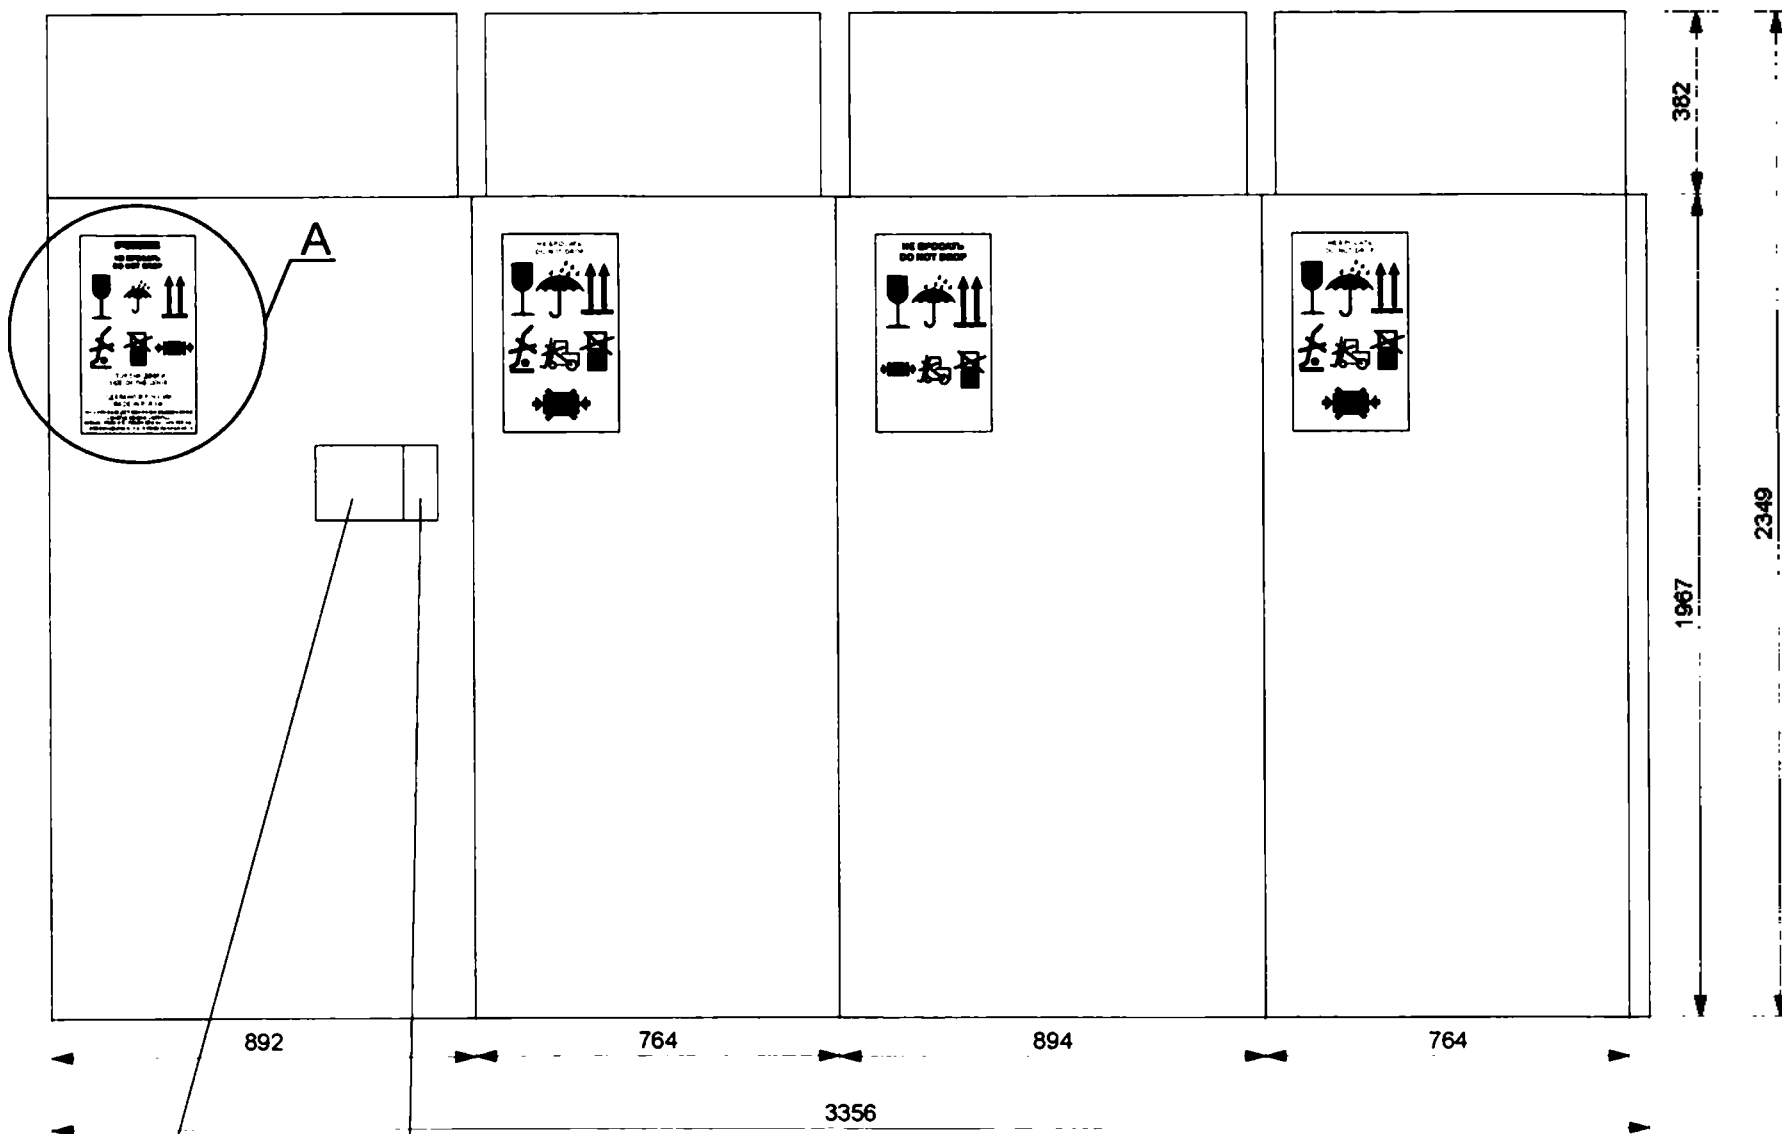


МЕСТО НАНЕСЕНИЯ ШТРИХОВОГО КОДА

МЕСТО НАНЕСЕНИЯ ЯРЛЫКА

Морозильники медицинские
ММШ-220 «POZIS», ММШ-350 «POZIS»
Фотографии комплектующих.

Примечание: применение комплектующего в той или иной модели - в соответствии с таблицей комплектности поставки, указанной в ТУ 9452-195-07503307-2008

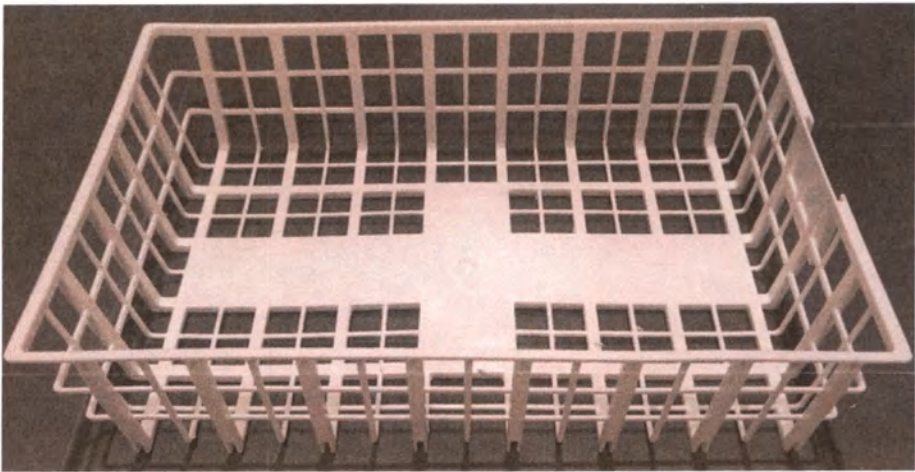Наименование комплектующего в соответствии с ТУ 9452-195-07503307-2008	Фотографическое изображение
1	2
Кассета	
Ключи	

В данном документе прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью (19) ДЕВОТНАЦАТЬ листов(а)
Начальник общего отдела Ю.В. Журина
_____ 20__ г.

