

# МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

**Микрокатетер TRUSELECT, эффективная длина 105 см, внутренний диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), наружный диаметр дистального кончика 2F (0,66 мм), прямой кончик, в составе:**

**1 Микрокатетер TRUSELECT, эффективная длина 105 см, внутренний диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), наружный диаметр дистального кончика 2F (0,66 мм), прямой кончик, – 1 шт./уп.**

**2 Интродьюсер – 1 шт./уп.**

**3 Формирующий мандрен – 1 шт./уп.**

**4 Инструкция по применению.**

**Регистрационное удостоверение:**

**От:**

**только для одноразового использования**

**Нетоксично**

**Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке**

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

**Микрокатетер TRUSELECT, эффективная длина 130 см, внутренний диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), наружный диаметр дистального кончика 2F (0,66 мм), прямой кончик, в составе:**

**1 Микрокатетер TRUSELECT, эффективная длина 130 см, внутренний диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), наружный диаметр дистального кончика 2F (0,66 мм), прямой кончик, – 1 шт./уп.**

**2 Интродьюсер – 1 шт./уп.**

**3 Формирующий мандрен – 1 шт./уп.**

**4 Инструкция по применению.**

**Регистрационное удостоверение:**

**От:**

**только для одноразового использования**

**Нетоксично**

**Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке**

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

**Микрокатетер TRUSELECT, эффективная длина 155 см, внутренний диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), наружный диаметр дистального кончика 2F (0,66 мм), прямой кончик, в составе:**

**1 Микрокатетер TRUSELECT, эффективная длина 155 см, внутренний диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), наружный диаметр дистального кончика 2F (0,66 мм), прямой кончик, – 1 шт./уп.**

**2 Интродьюсер – 1 шт./уп.**

**3 Формирующий мандрен – 1 шт./уп.**

**4 Инструкция по применению.**

**Регистрационное удостоверение:**

**От:**

**только для одноразового использования**

**Нетоксично**

**Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке**

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

**Микрокатетер TRUSELECT, эффективная длина 175 см, внутренний диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), наружный диаметр дистального кончика 2F (0,66 мм), прямой кончик, в составе:**

**1 Микрокатетер TRUSELECT, эффективная длина 175 см, внутренний диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), наружный диаметр дистального кончика 2F (0,66 мм), прямой кончик, – 1 шт./уп.**

**2 Интродьюсер – 1 шт./уп.**

**3 Формирующий мандрен – 1 шт./уп.**

**4 Инструкция по применению.**

**Регистрационное удостоверение:**

**От:**

**только для одноразового использования**

**Нетоксично**

**Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке**

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

**Микрокатетер TRUSELECT, эффективная длина 105 см, внутренний диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), наружный диаметр дистального кончика 2F (0,66 мм), кончик типа Bern, в составе:**

**1 Микрокатетер TRUSELECT, эффективная длина 105 см, внутренний диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), наружный диаметр дистального кончика 2F (0,66 мм), кончик типа Bern, – 1 шт./уп.**

**2 Интродьюсер – 1 шт./уп.**

**3 Инструкция по применению.**

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

**Нетоксично**

**Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке**

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

**Микрокатетер TRUSELECT, эффективная длина 130 см, внутренний диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), наружный диаметр дистального кончика 2F (0,66 мм), кончик типа Bern, в составе:**

**1 Микрокатетер TRUSELECT, эффективная длина 130 см, внутренний диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), наружный диаметр дистального кончика 2F (0,66 мм), кончик типа Bern, – 1 шт./уп.**

**2 Интродьюсер – 1 шт./уп.**

**3 Инструкция по применению.**

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

**Нетоксично**

**Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке**

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

**Микрокатетер TRUSELECT, эффективная длина 155 см, внутренний диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), наружный диаметр дистального кончика 2F (0,66 мм), кончик типа Bern, в составе:**

**1 Микрокатетер TRUSELECT, эффективная длина 155 см, внутренний диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), наружный диаметр дистального кончика 2F (0,66 мм), кончик типа Bern, – 1 шт./уп.**

**2 Интродьюсер – 1 шт./уп.**

**3 Инструкция по применению.**

**Регистрационное удостоверение:**

**От:**

**только для одноразового использования**

**Нетоксично**

**Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке**

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

**Микрокатетер TRUSELECT, эффективная длина 175 см, внутренний диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), наружный диаметр дистального кончика 2F (0,66 мм), кончик типа Bern, в составе:**

**1 Микрокатетер TRUSELECT, эффективная длина 175 см, внутренний диаметр 0,021 дюйма (0,53 мм), наружный диаметр дистального кончика 2F (0,66 мм), кончик типа Bern, – 1 шт./уп.**

**2 Интродьюсер – 1 шт./уп.**

**3 Инструкция по применению.**

**Регистрационное удостоверение:**

**От:**

**только для одноразового использования**

**Нетоксично**

**Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке**

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте [www.adobe.com](http://www.adobe.com). Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Генеральный директор  
Шевчук Е.В.

ПРОШТО И  
ПРОНУМЕРОВАНО


5

ЛИСТОВ




# **ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**Микрокатетер TRUSELECT в составе, варианты  
исполнения**

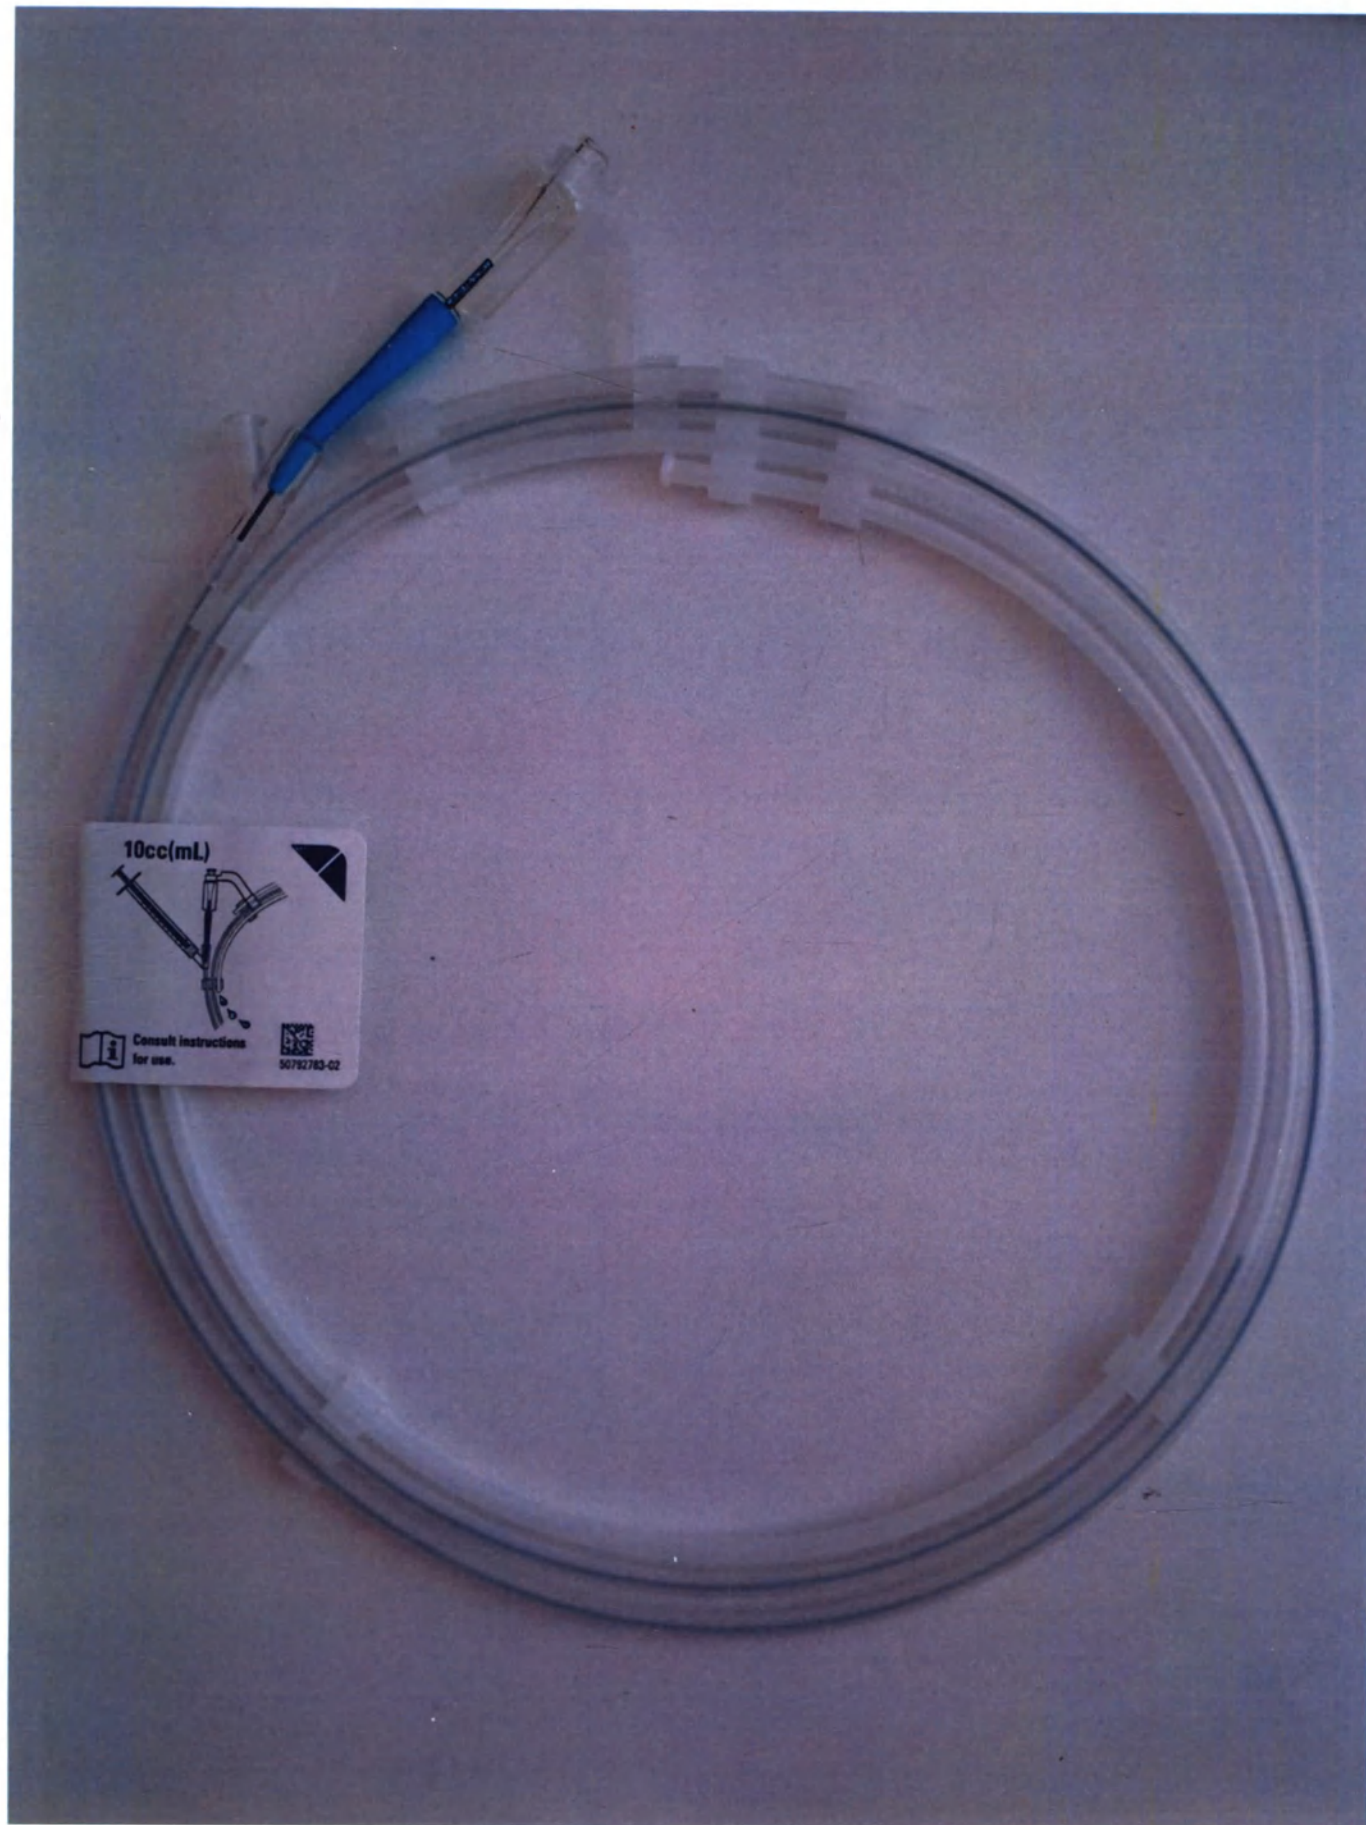


Микрокатетер TRUSELECT, прямой кончик в защитной трубке в сборе

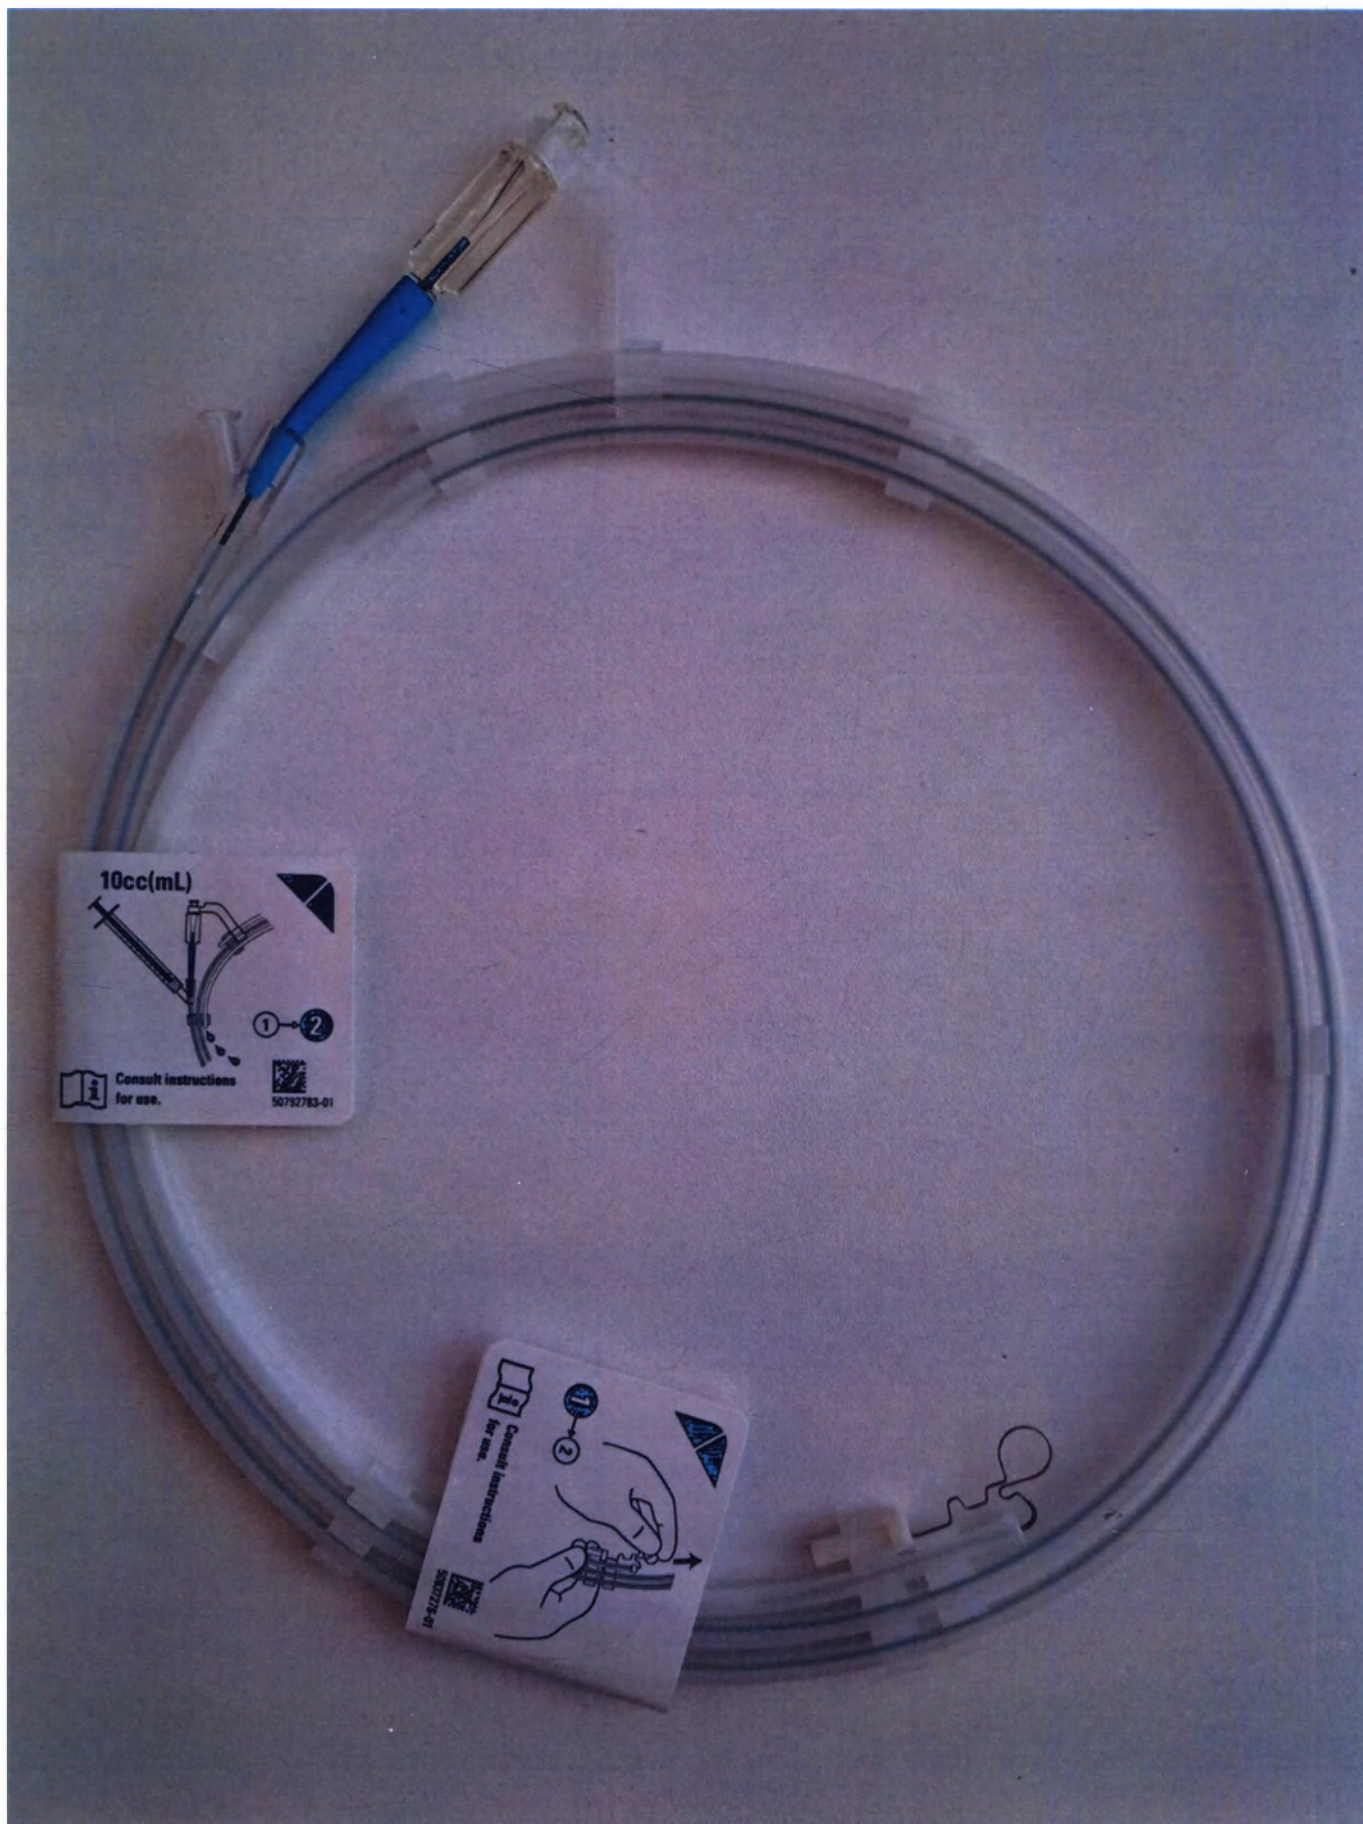

Микрокатетер TRUSELECT, кончик типа Bern в защитной трубке в сборе

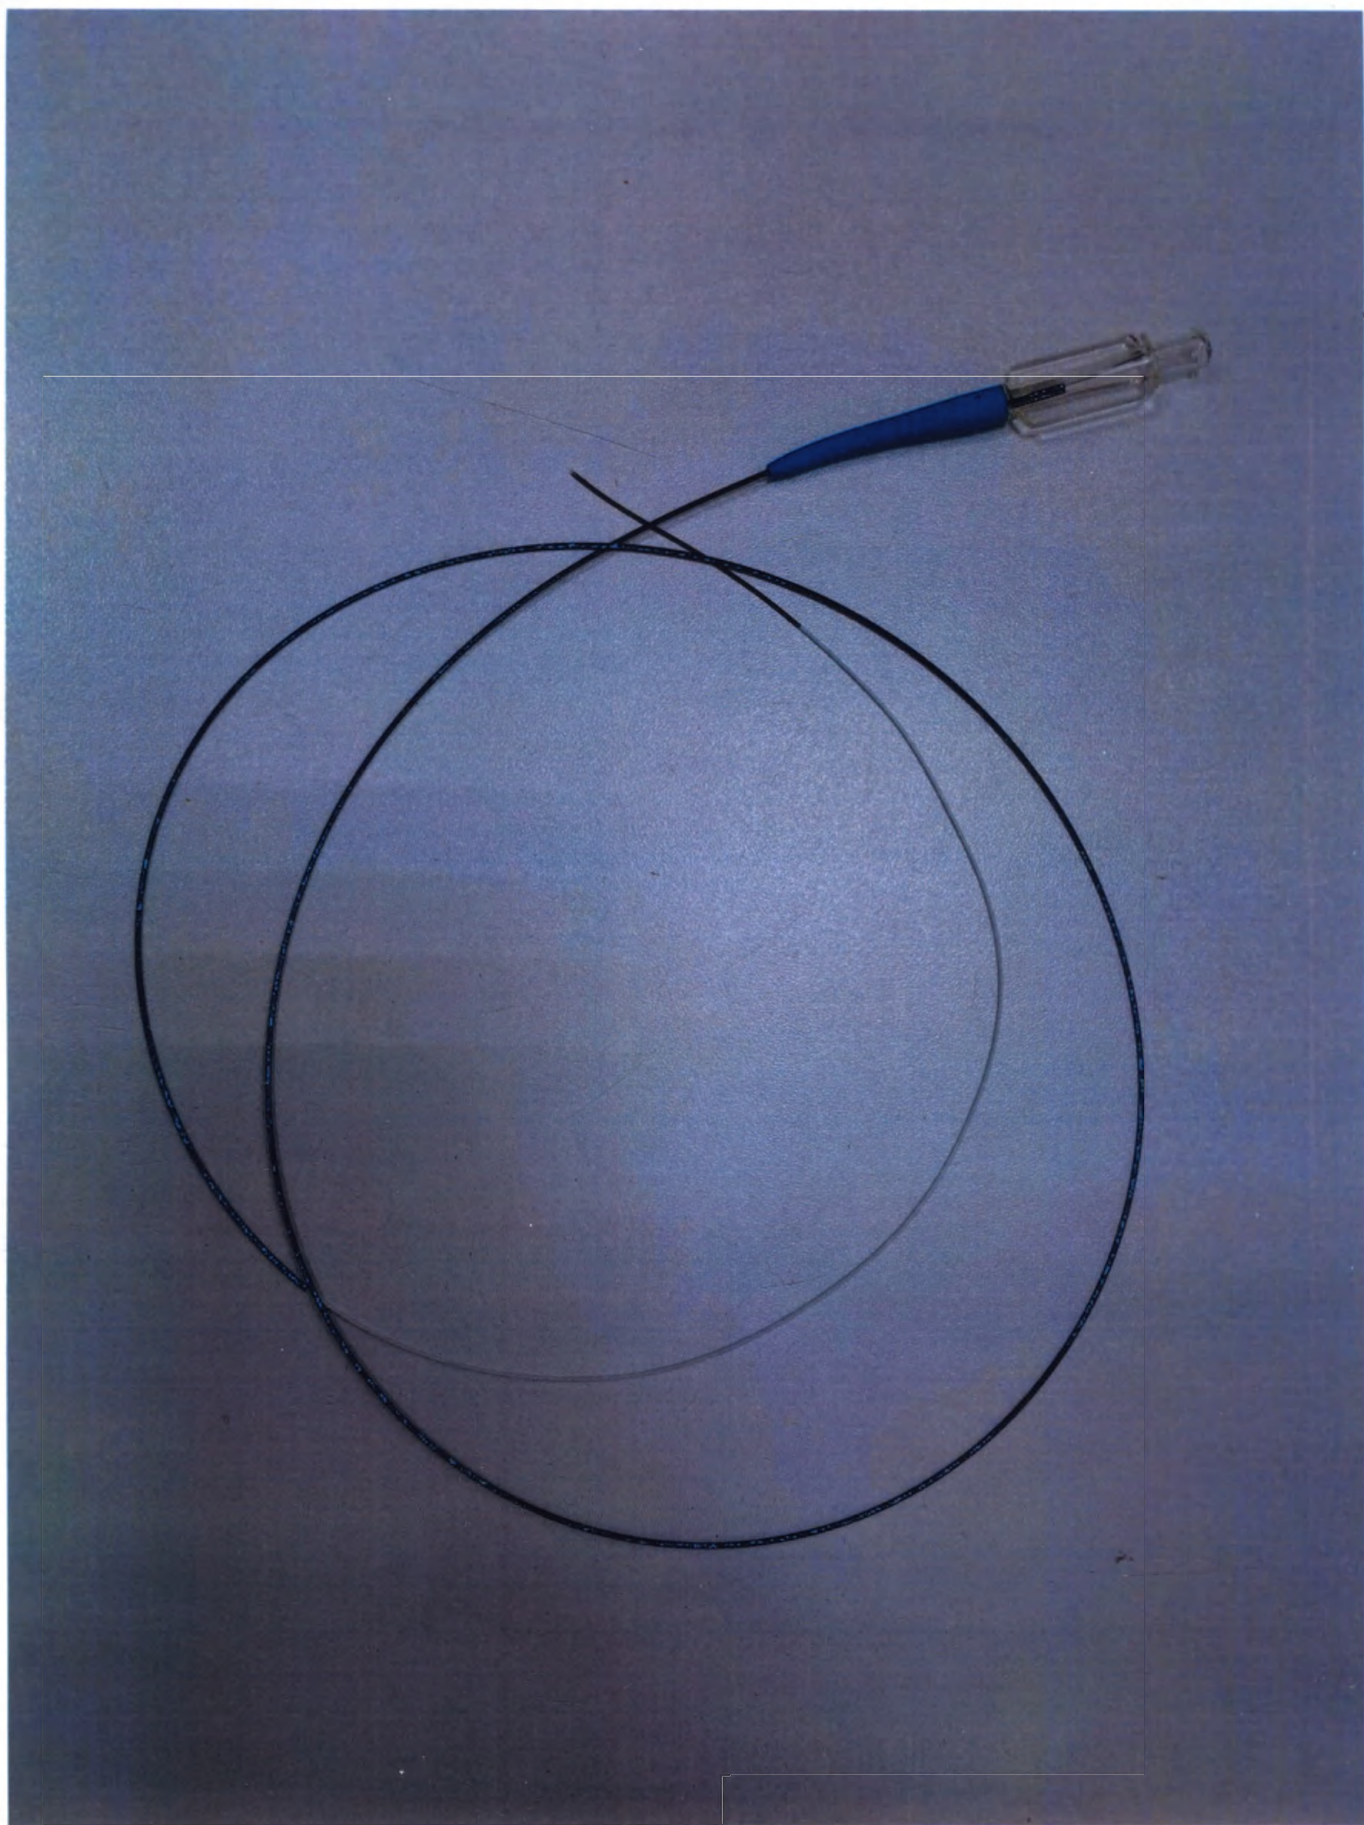



Микрокатетер TRUSELECT, прямой кончик

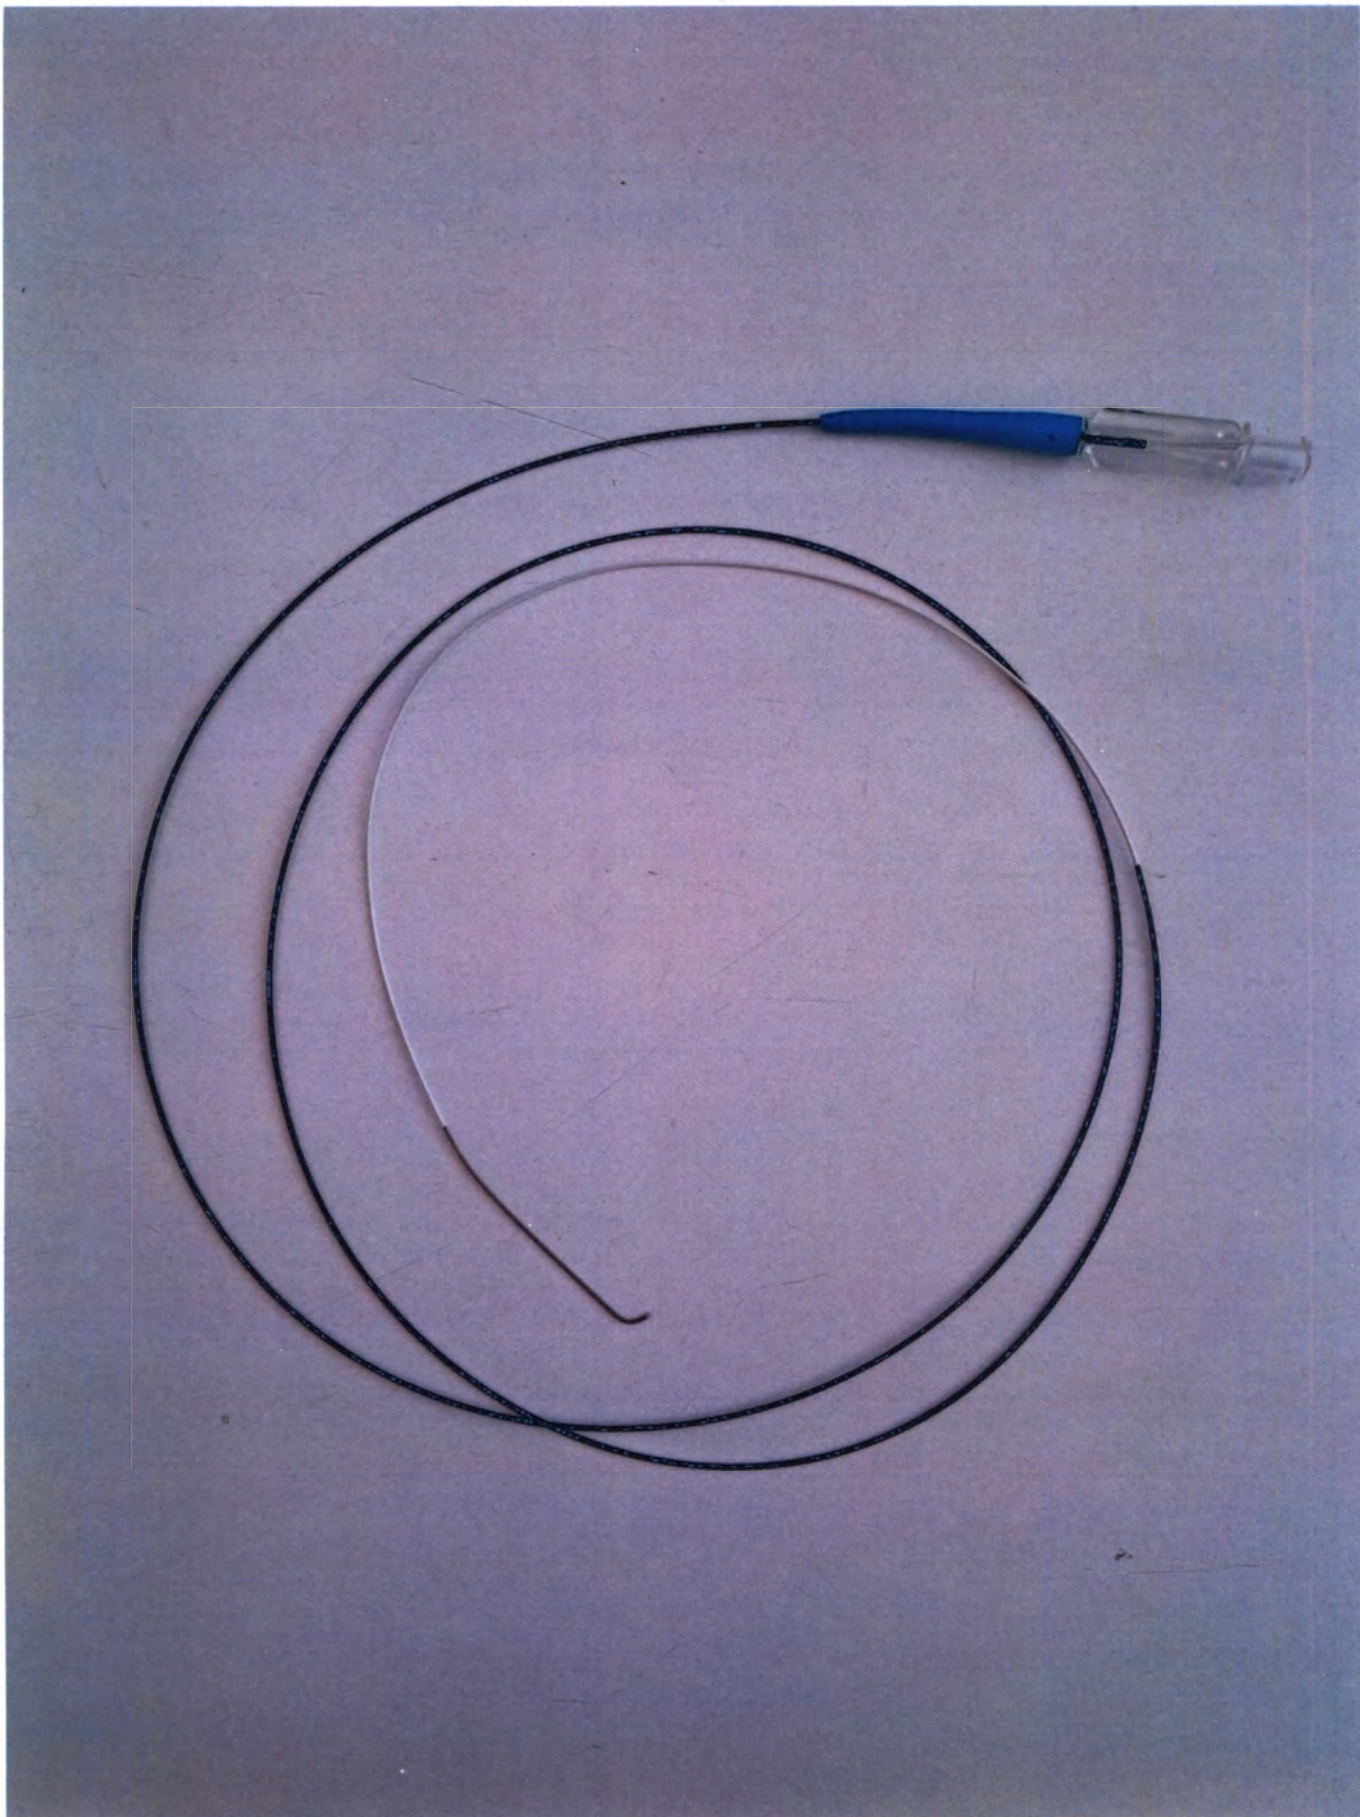

Микрокатетер TRUSELECT, кончик типа Bern

Шаг 1

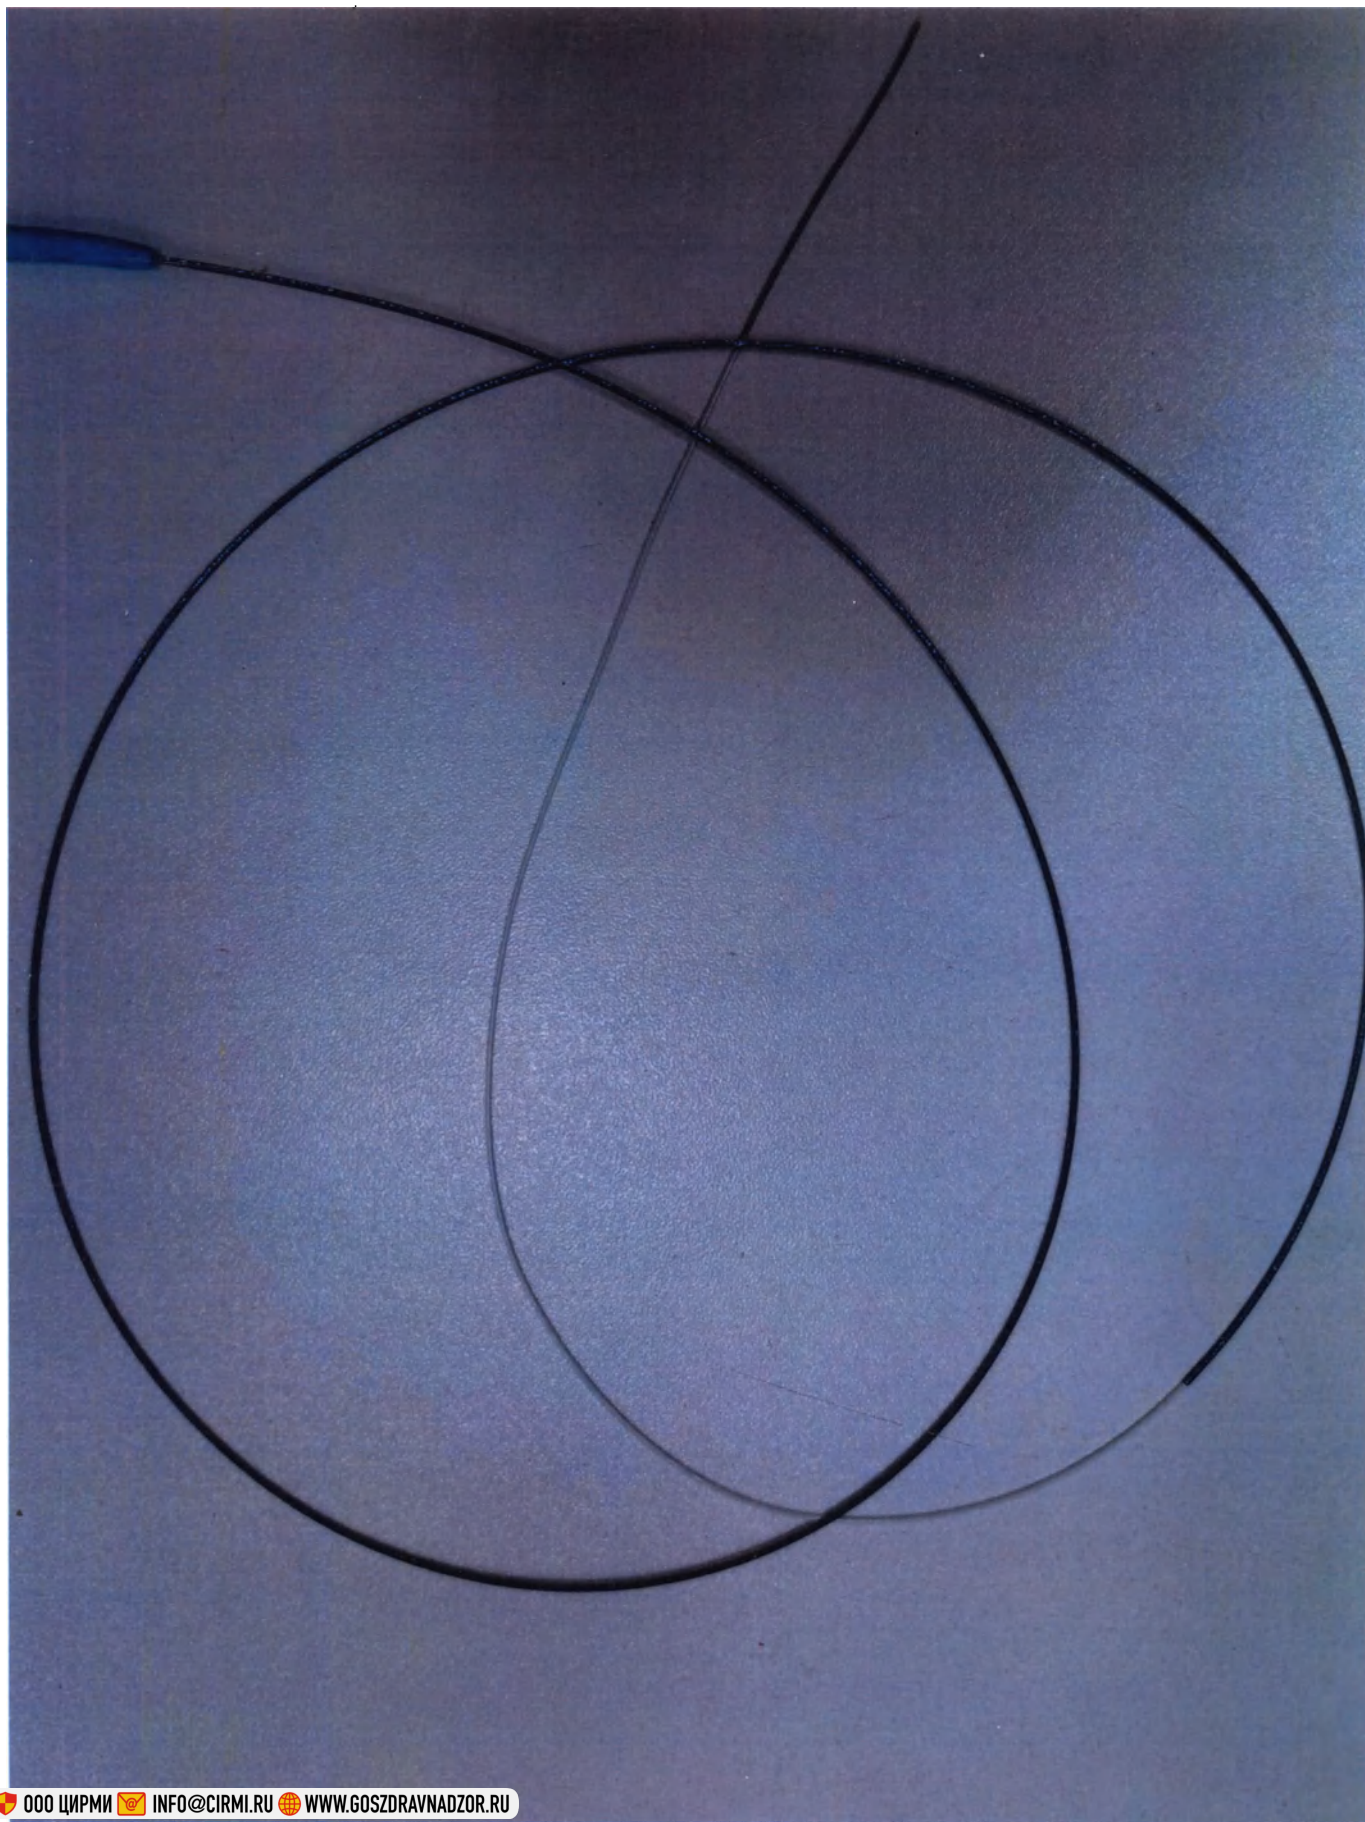


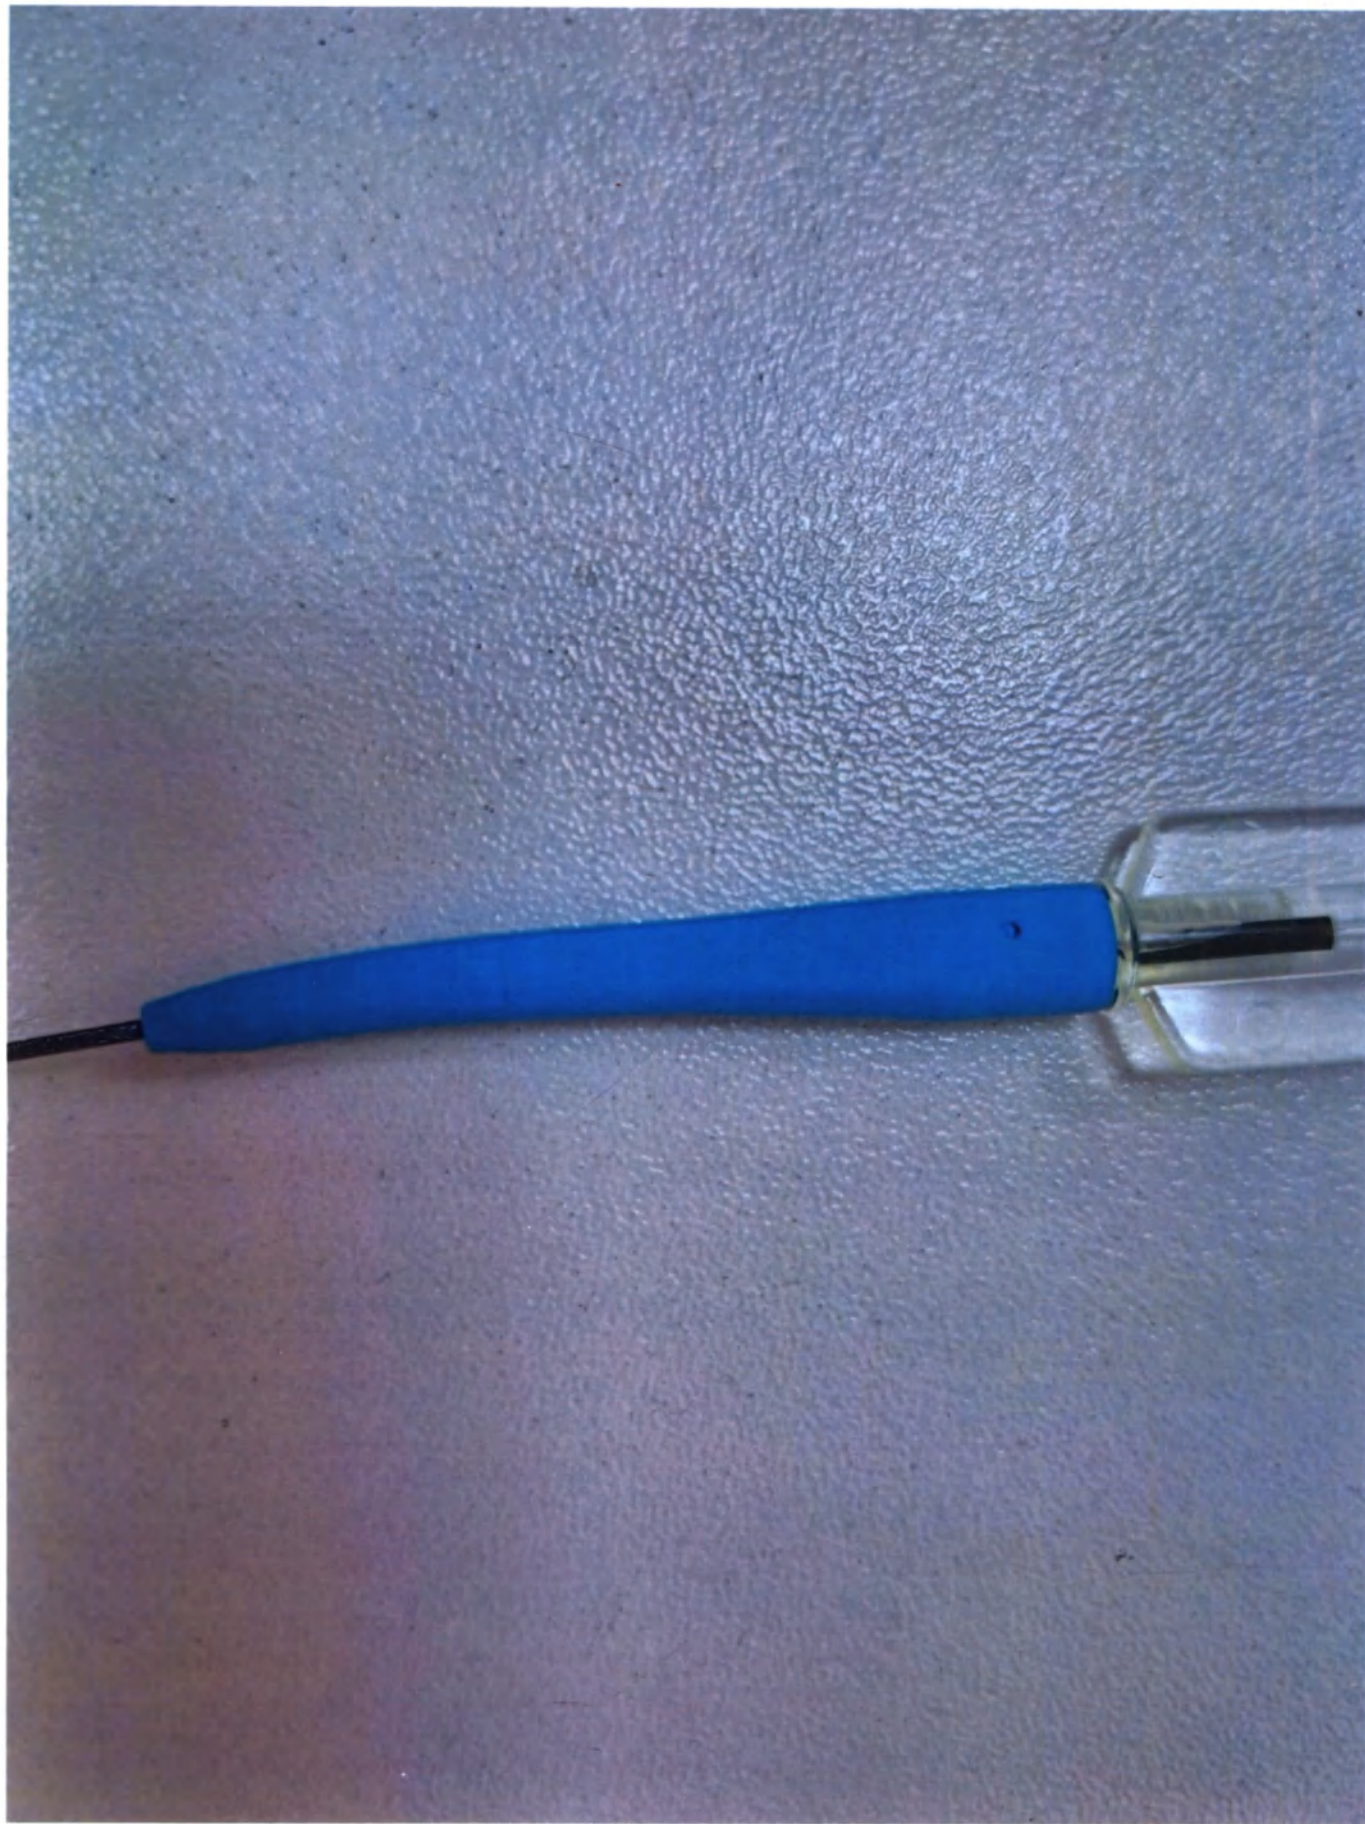


Разгрузочная муфта

Xa6




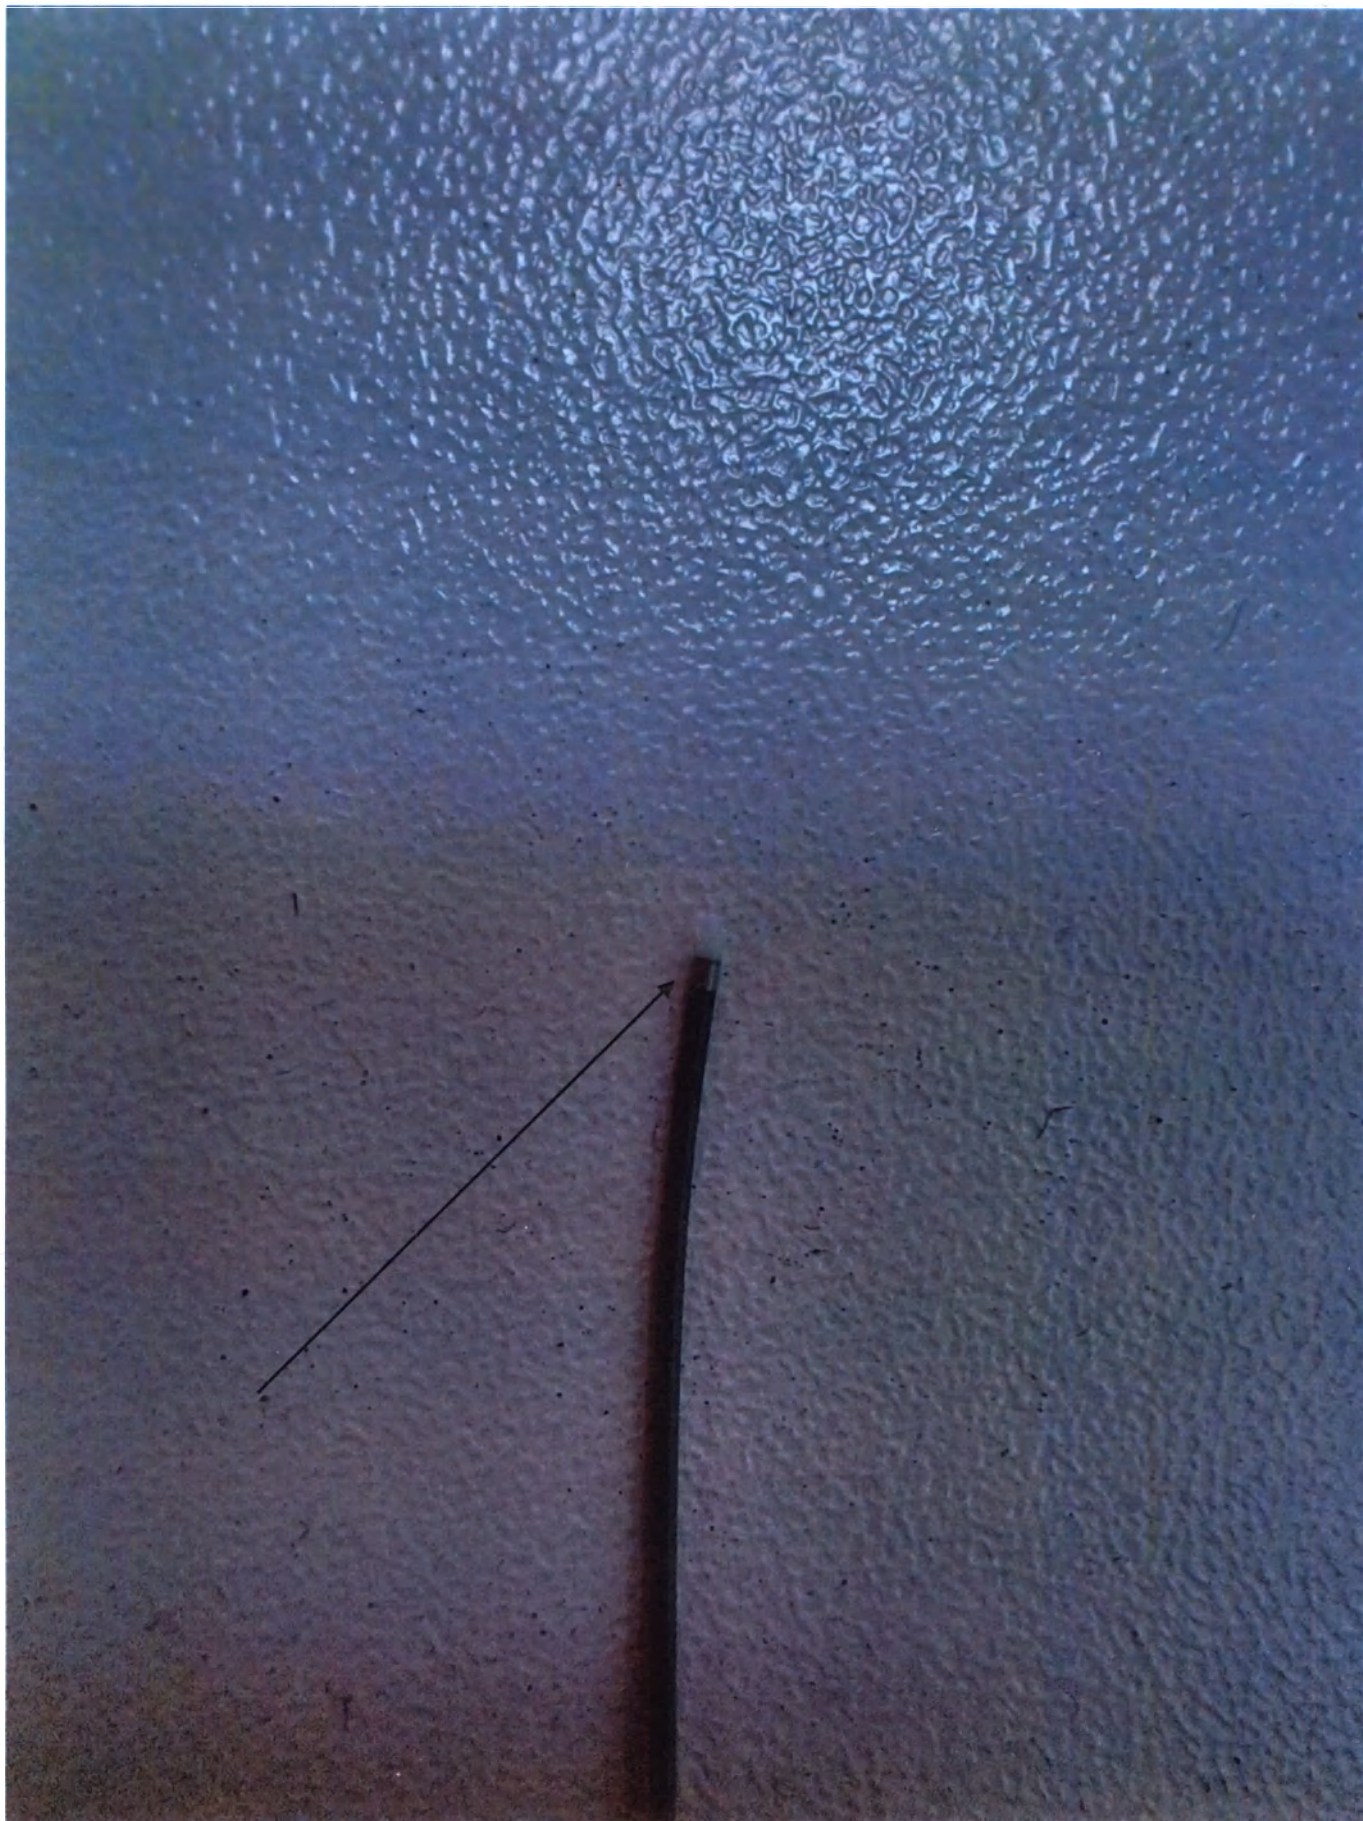

Рентгеноконтрастный маркер

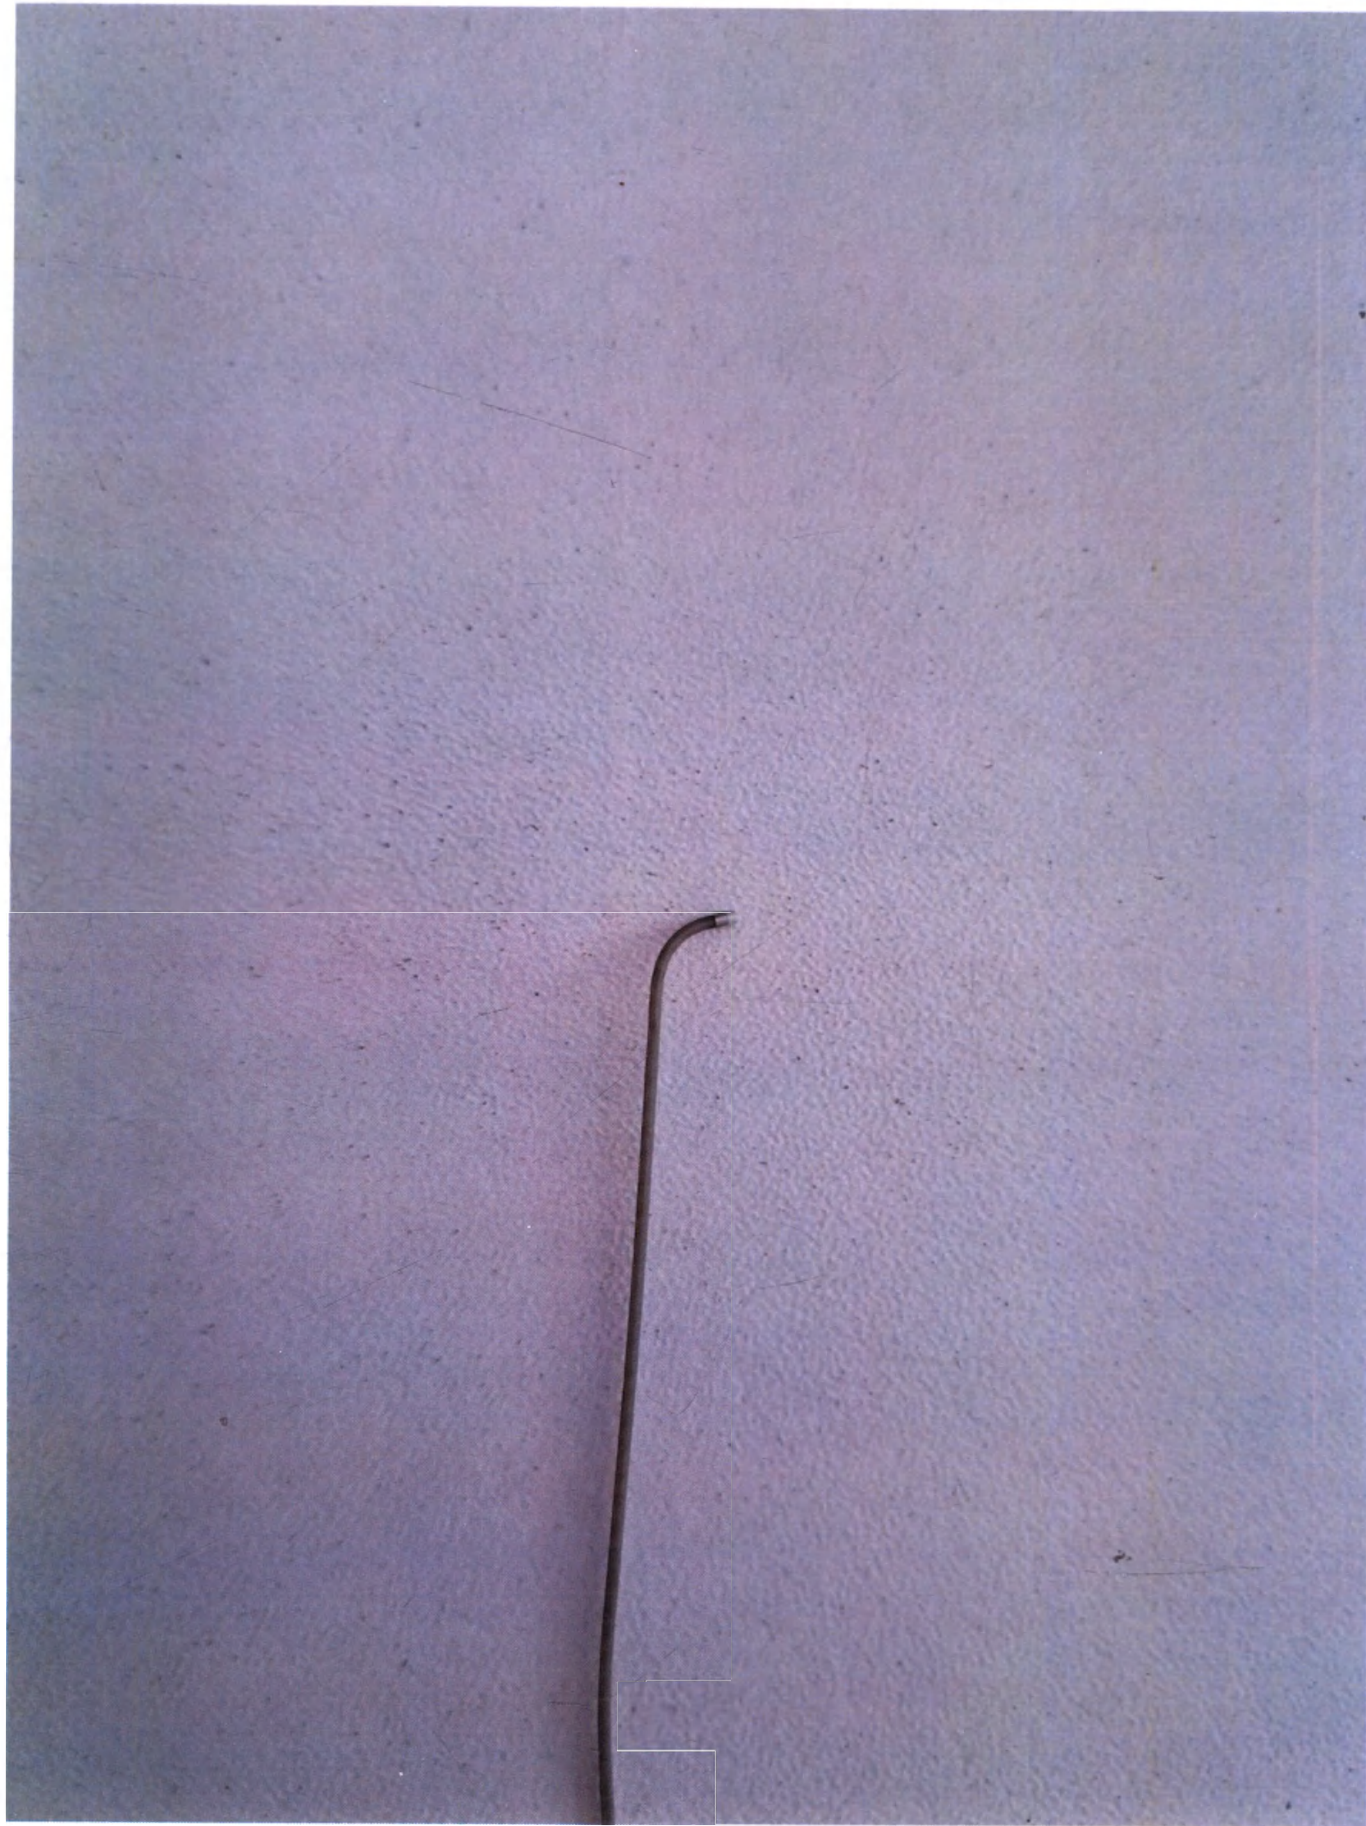


Кончик типа Bern

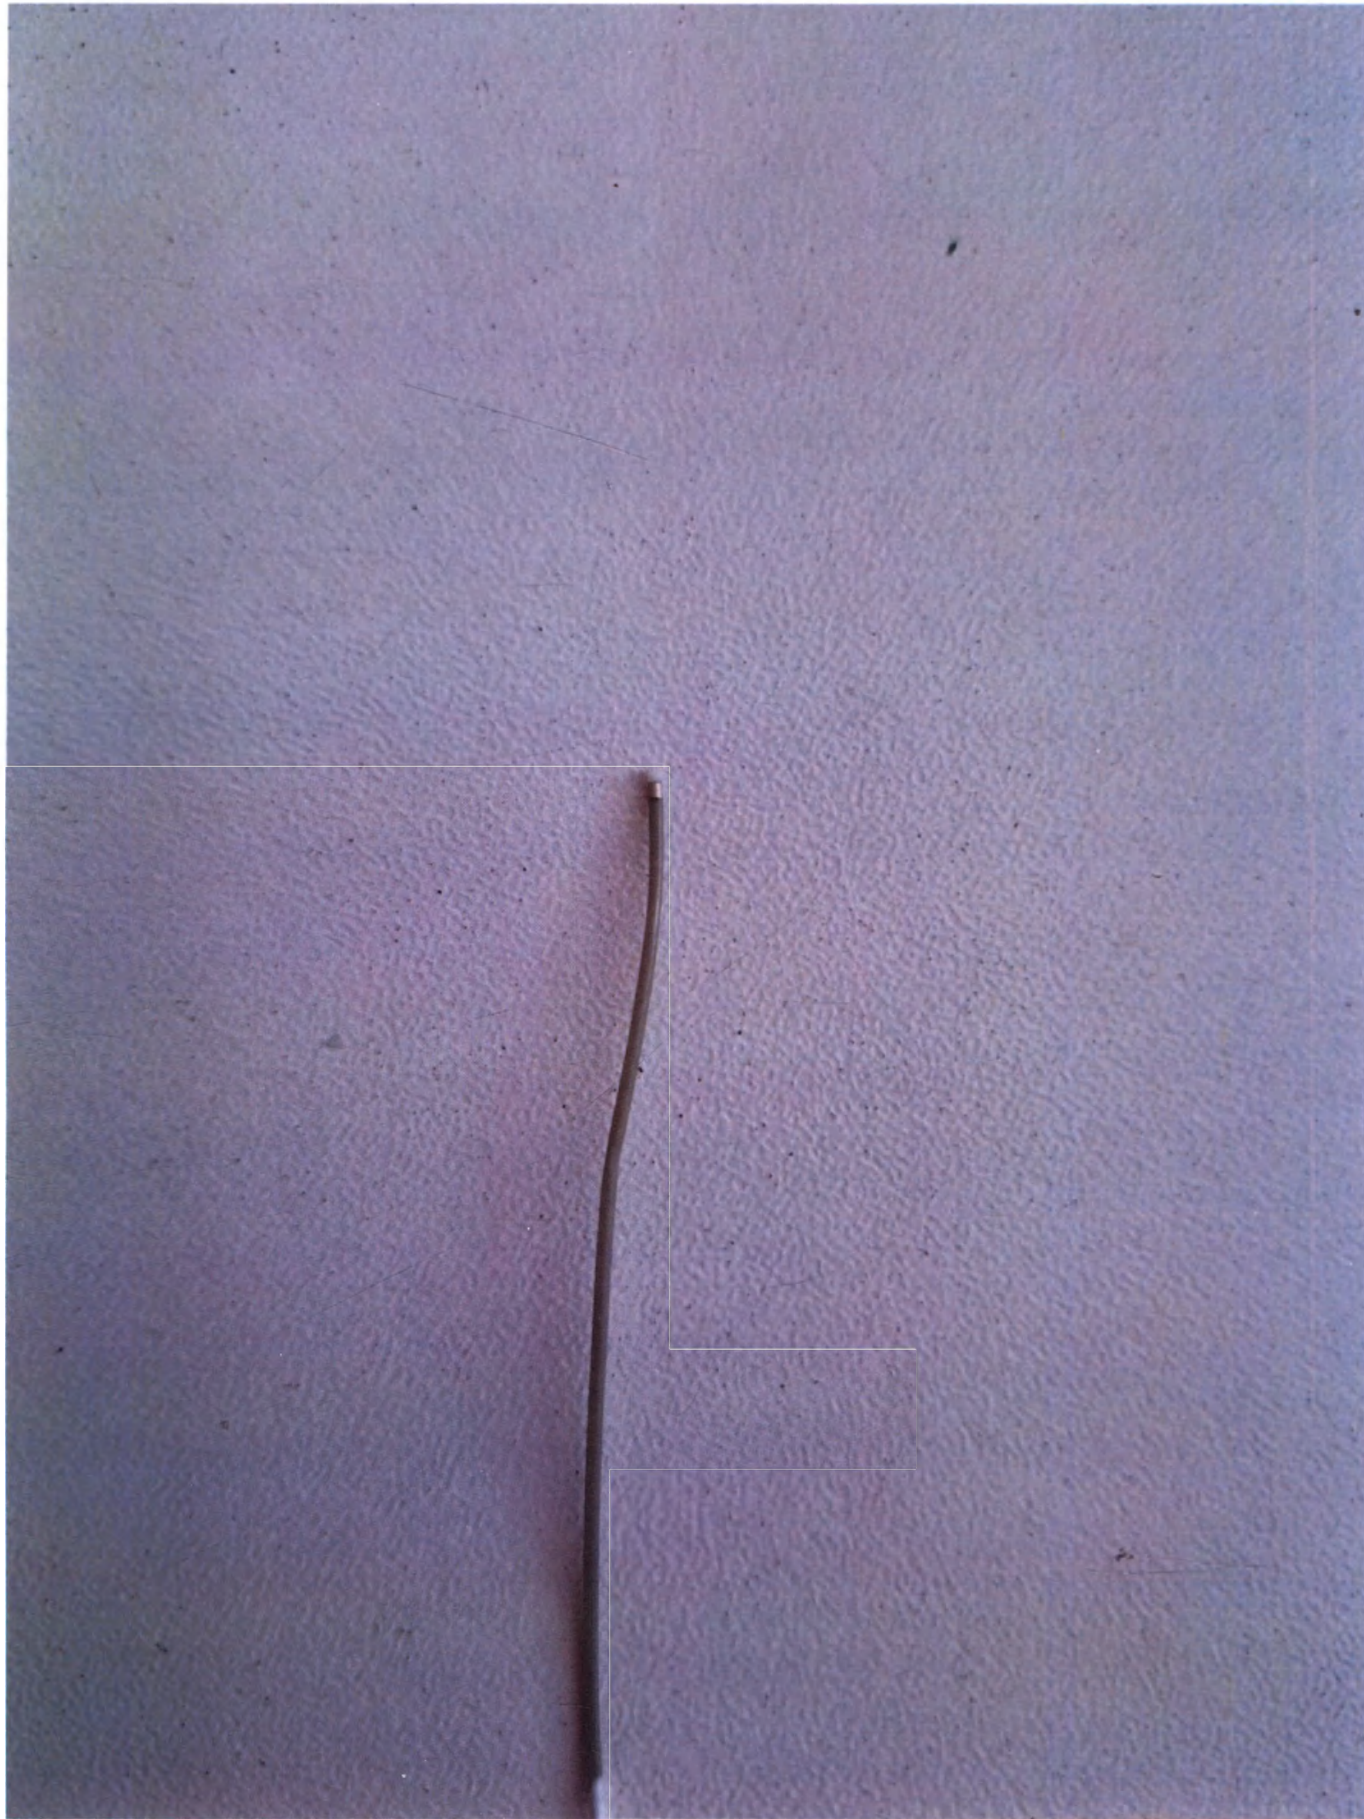

Прямой кончик

10cc(mL)

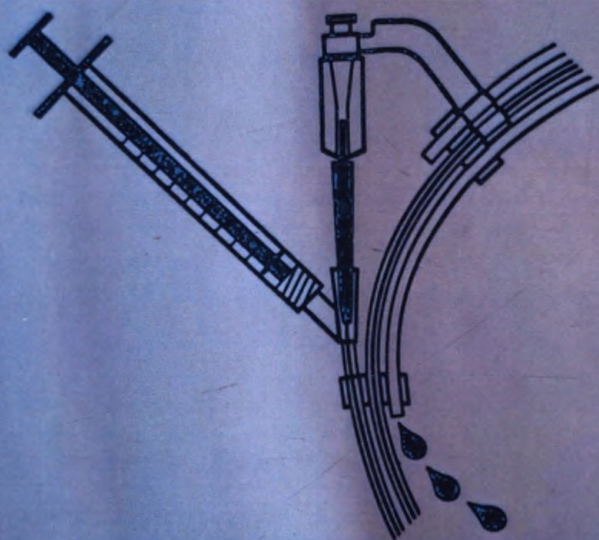

**Consult instructions  
for use.**



50792783-02

Предупредительная этикетка о промывке (для вариантов исполнения с прямым кончиком)




Предупредительная этикетка о промывке (для вариантов исполнения с кончиком типа Bern)




Предупредительная этикетка об извлечении формирующего мандрена (только для вариантов исполнения с кончиком типа Bern)




Дополнительный пакет

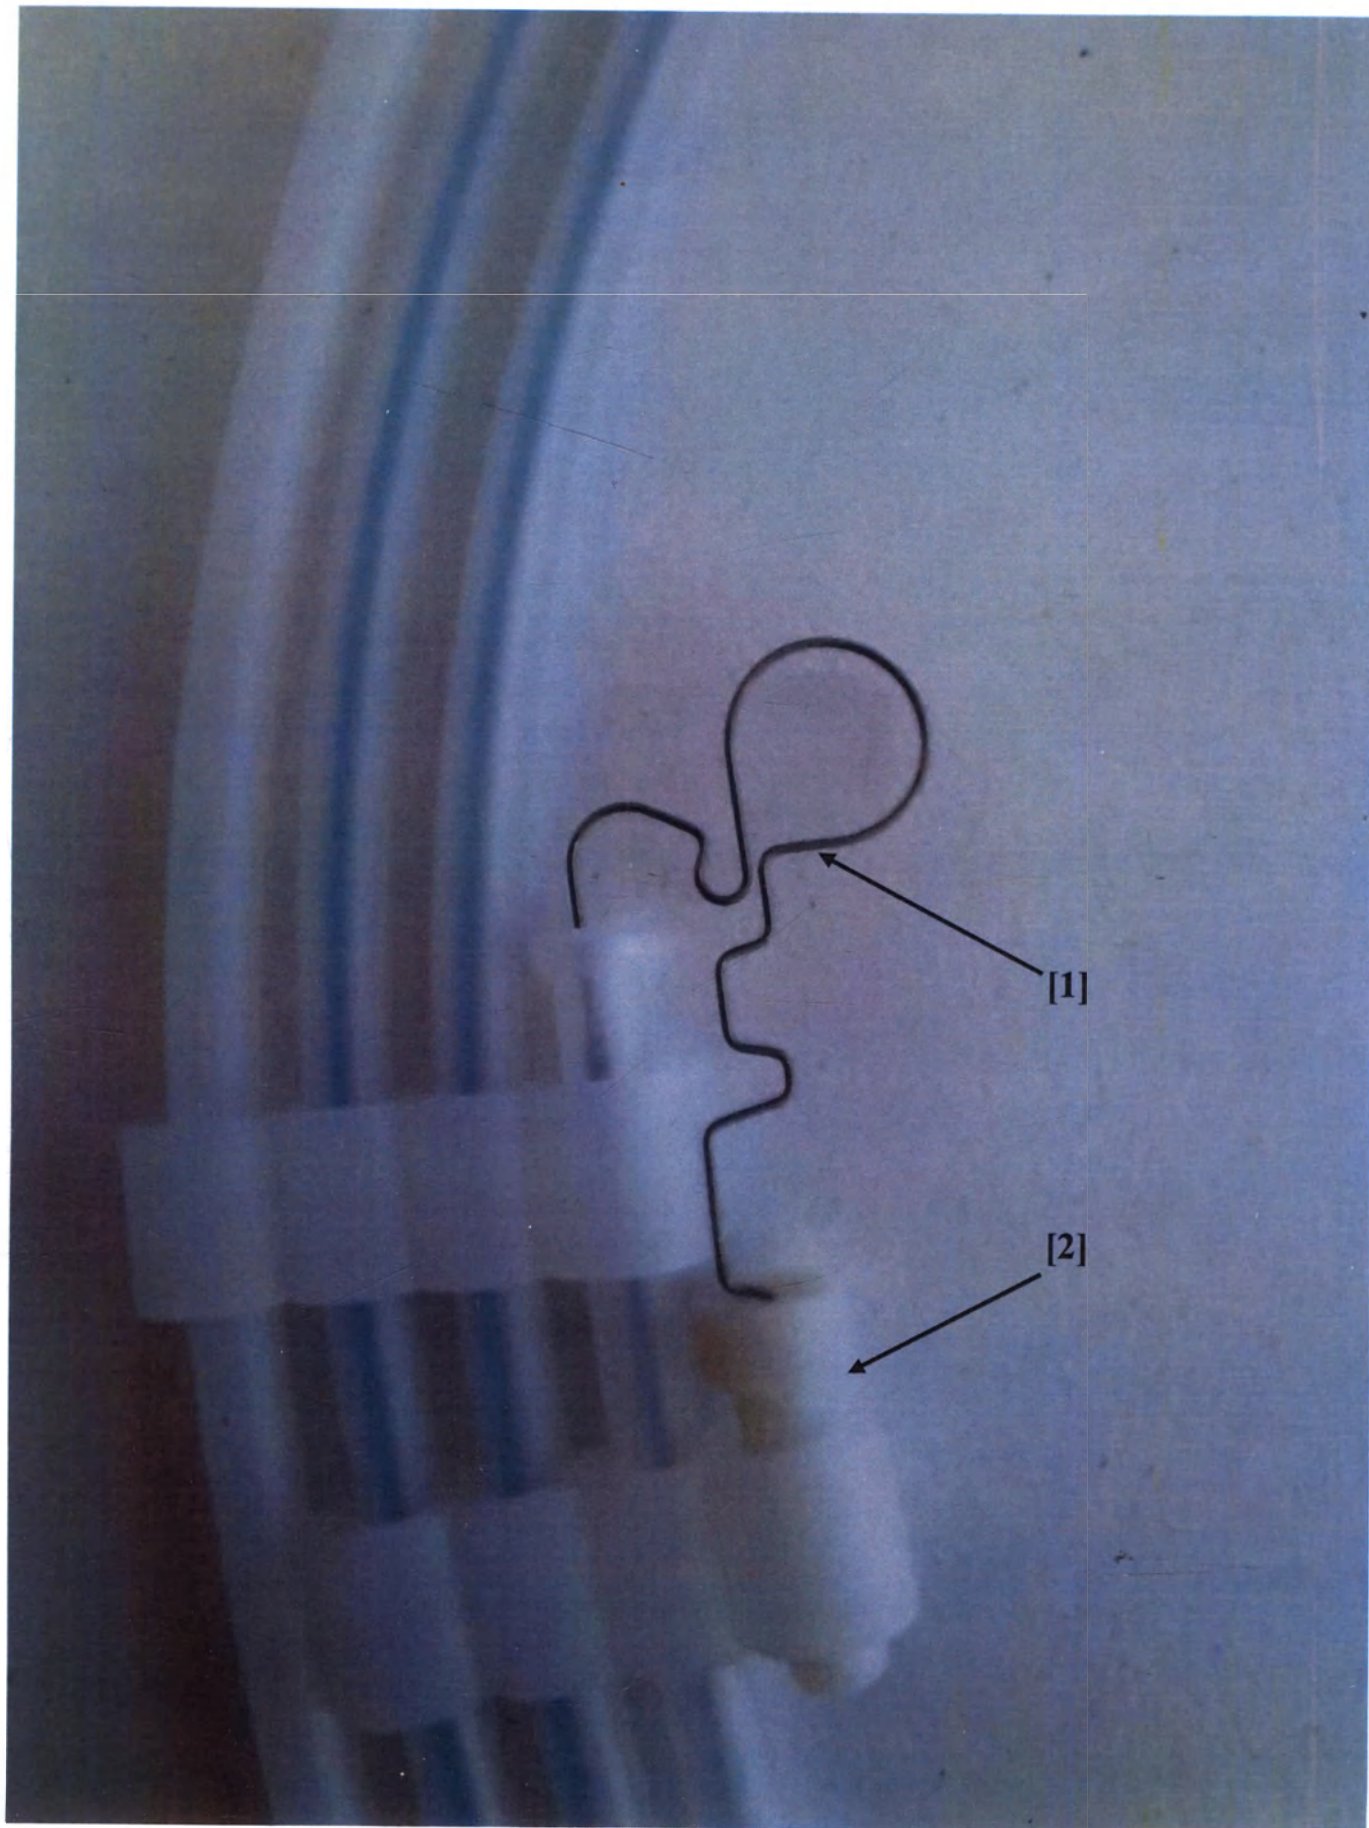

Формирующий мандрен [1] и проксимальная втулка [2] (для вариантов исполнения с кончиком типа Bern)

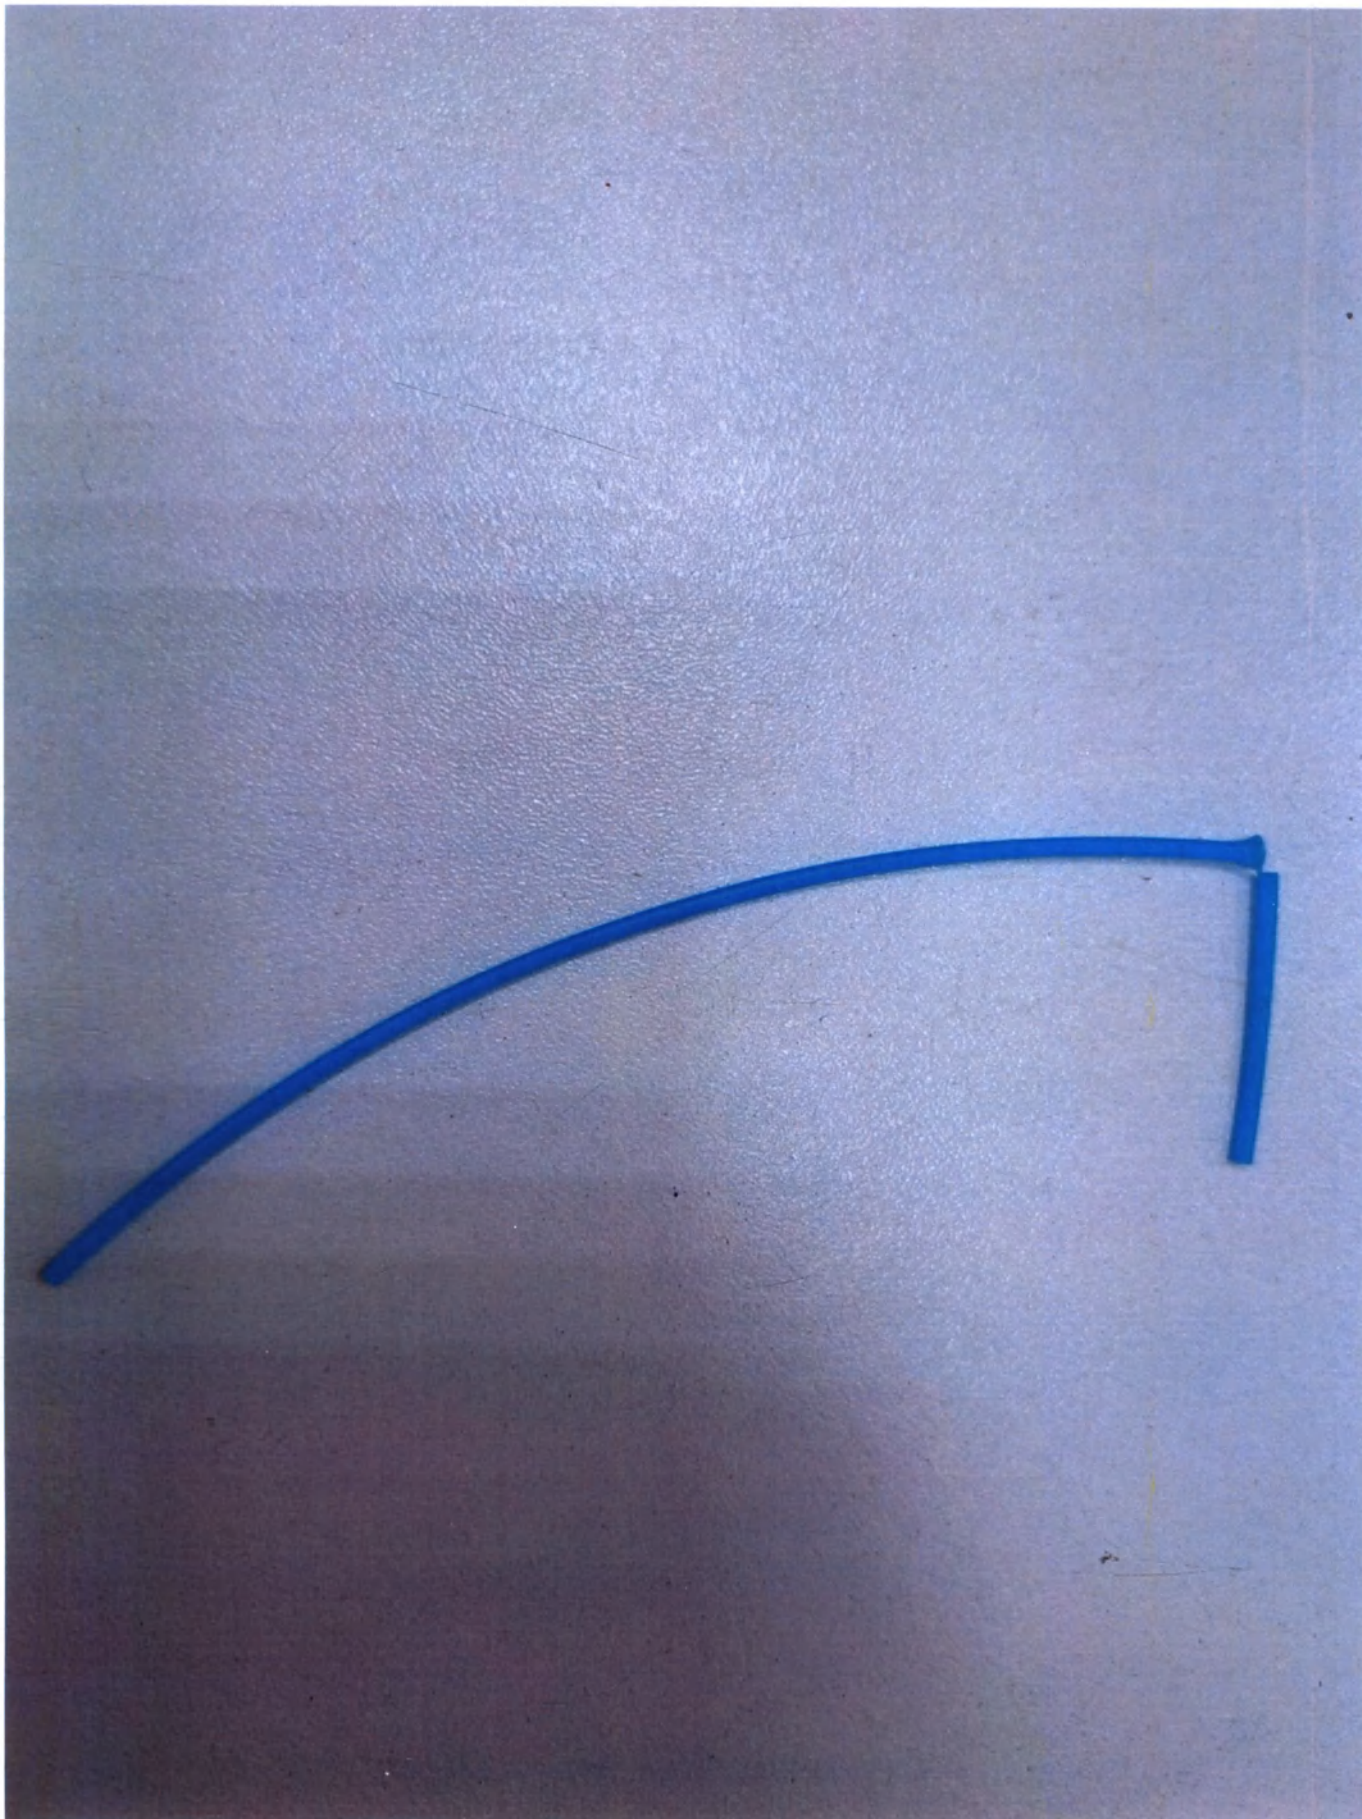

Интродьюсер

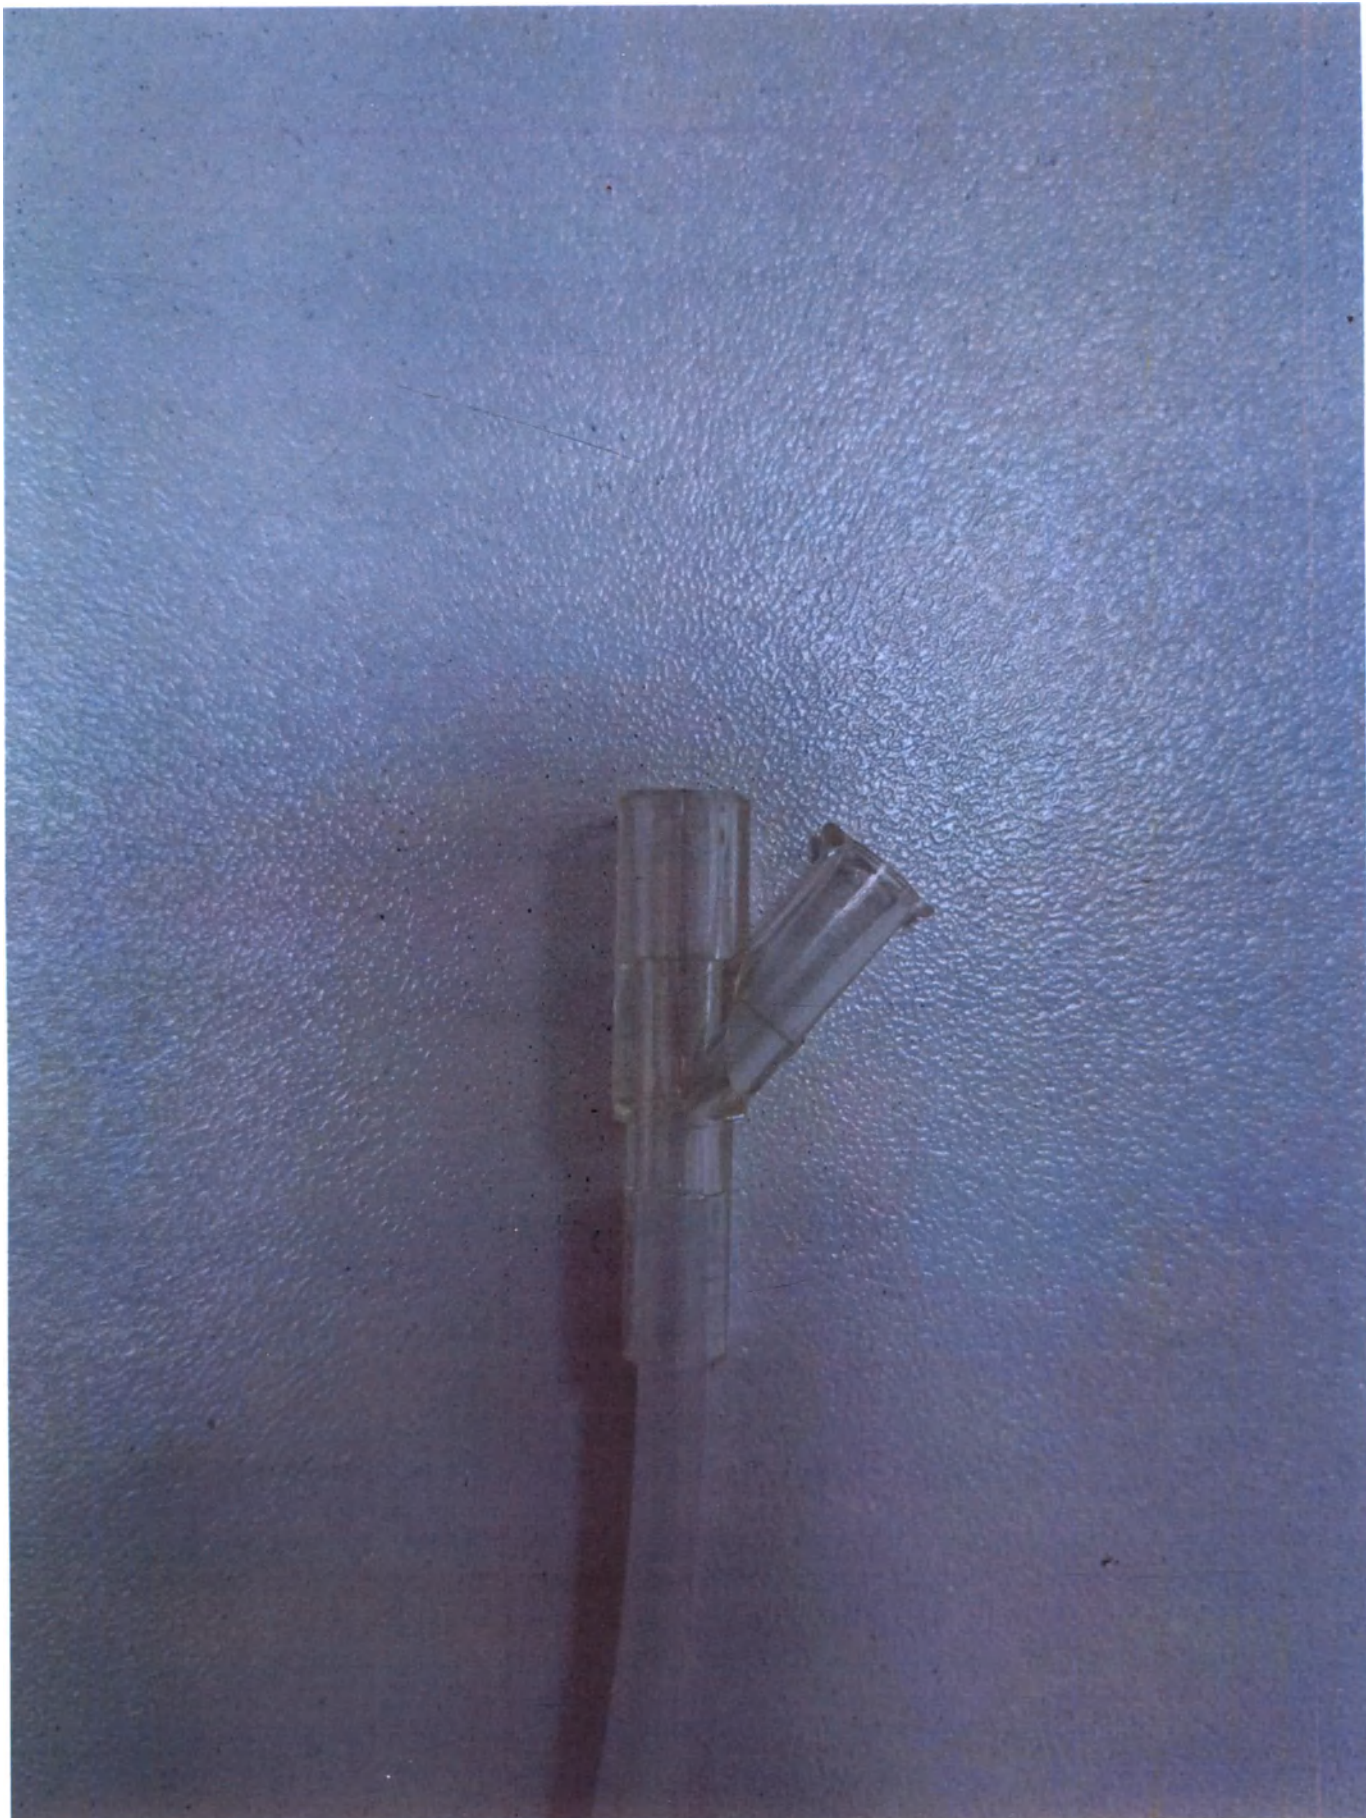

**Y-образный коннектор**



Пример коробки для медицинского изделия Микрокатетер TRUSELECT, прямой кончик (сторона 1)

Kinship Scientific Corporation  
300 Worcester Scientific Way  
Marlborough, MA 01757  
USA  
USA Customer Service: +1-800-






Пример коробки для медицинского изделия Микрокатетер TRUSELECT, кончик типа Bern (сторона 1)

☒ Non-Pyrogenic

 **ООО ЦИПМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**





 ООО ЦИПМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:INFO@CIRMI.RU)  [WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU](http://WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU)



Запечатываемый пакет (сторона 2)

Генеральный директор  
Шевчук Е.В.

ПРОШТО И  
ПРОНУМЕРАНО

26 ЛИСТОВ

