

ФОТО

АППАРАТ ИВЛ ВЗРОСЛО-ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЭМО500 по ТУ 32.50.21-034-15168277-2012

Производства: Акционерное общество «Завод «Электромедоборудование»

Комплектность поставки:

1. Аппарат ИВЛ взросло-педиатрический ЭМО500 в составе:

1.1 Стойка – 1 шт. (при необходимости)

1.2 Шланг воздуха – 1 шт.

1.3 Шланг кислорода – 1 шт.

1.4 Кабель подключения датчика потока – 1 шт.

1.5 Монитор качества респираторной поддержки (МКРП) с метабологом – 1 шт. (при необходимости)

1.6 Блок ИВЛ взросло-педиатрический – 1 шт.

1.7 Упаковка – 1 шт.

1.8 Увлажнитель дыхательных смесей MR850 с принадлежностями, производитель "Фишер энд Пейкел Хелскэр Лтд.", Новая Зеландия, РУ № РЗН 2014/1416 – 1 шт. (при необходимости)

1.9 Увлажнитель дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких с принадлежностями, производитель «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань, РУ № ФСЗ 2010/08292 - 1 шт. (при необходимости)

в комплекте с

1.9.1 Камерой увлажнителя, вариант исполнения G-314002, производитель «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань – 1 шт. (при необходимости)

1.10 Увлажнитель дыхательных смесей ТЕВЛАР – «УОМЗ» по АМНК.941629.001ТУ (ТУ 32.50.21-121-07539541-2018). Вариант исполнения 3703.00000000, производитель АО «ПО УОМЗ», Россия, РУ № РЗН 2015/2620 – 1 шт. (при необходимости)

в составе

1.10.1 Блок управления 3703.01100000, производитель АО «ПО УОМЗ», Россия - 1 шт. (при необходимости);

1.10.2 Камера увлажнителя многоцветная 3703.20000501, производитель АО «ПО УОМЗ», Россия - 1 шт. (при необходимости)

1.10.3 Датчик температуры / влажности 3703.41000000, производитель АО «ПО УОМЗ», Россия - 1 шт. (при необходимости)

1.11 Контур дыхательный взрослый многоцветный, вариант исполнения G-328000, производитель «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань, – не более 20 шт. (при необходимости)

1.12 Контур дыхательный взрослый одноканальный, вариант исполнения G-316001 или G-316001-1, производитель «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань – не более 20 шт. (при необходимости)

1.13 Комплект дыхательного контура для аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких КД-«МС-1» по ТУ 9398-001-72474991-2005, производитель ООО «Медсиликон», Россия, РУ № ФСР 2010/07116 – не более 20 шт. (при необходимости)

1.14 Контур дыхательный детский многоцветный, вариант исполнения G-330000, производитель «ВАДИ Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.», Тайвань – не более 20 шт. (при необходимости)

1.15 Контур дыхательный, производитель "Ковидиен Ллс", США, РУ № ФСЗ 2011/11170 – не более 20 шт. (при необходимости)

1.16 Небулайзер Aeroneb с принадлежностями, вариант исполнения Aeroneb Pro – производитель "Аэроджен Лтд", Ирландия, РУ № ФСЗ 2010/08746 – 1 шт. (при необходимости)

1.17 Датчик потока SpiroQuant A+ Flowsensor, производитель EnviteC-Wismar GmbH, Германия - не более 10 шт. (при необходимости)

1.18 Датчик потока SpiroQuant H Flowsensor, производитель EnviteC-Wismar GmbH, Германия - не более 10 шт. (при необходимости)


1.19 Модуль газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы) ТЭСМ.506001, производитель ООО «Тритон-ЭлектроникС», Россия - 1 шт. (при необходимости)

в составе:


- 1.19.1 Датчик CO2 в прямом потоке, ТЭСМ.506138, производитель ООО «Тритон-ЭлектроникС», Россия - 1 шт. (при необходимости)
- 1.19.2 Вентиляционный адаптер взрослый/детский ТЭСМ.706020, производитель ООО «Тритон-ЭлектроникС», Россия - 1 шт. (при необходимости)
- 1.19.3 Вентиляционный адаптер детский/ неонатальный, ТЭСМ.706021, производитель ООО «Тритон-ЭлектроникС», Россия - 1 шт. (при необходимости)
- 1.20 Фильтр электростатический, производитель "Ковидиен Ллс", США, РУ № ФСЗ 2011/11170 - не более 20 шт. (при необходимости)
- 1.21 Маска, размер 5, производитель "Ковидиен Ллс", США, РУ № ФСЗ 2011/11170 - не более 20 шт. (при необходимости)
- 1.22 Маска, размер 4, производитель "Ковидиен Ллс", США, РУ № ФСЗ 2011/11170 - не более 20 шт. (при необходимости)
- 1.23 Маска, размер 3, производитель "Ковидиен Ллс", США, РУ № ФСЗ 2011/11170 - не более 20 шт. (при необходимости)
- 1.24 Мешок дыхательный, 2 л, производитель "Ковидиен Ллс", США, РУ № ФСЗ 2011/11170 - 1 шт. (при необходимости)
- 1.25 Коннектор, производитель "Ковидиен Ллс", США, РУ № ФСЗ 2011/11170 - не более 20 шт. (при необходимости)
- 1.26 Клапан выдоха – 1 шт.
- 1.27 Шнур сетевой ПК 3x0,75 5м IEC C13 – 1 шт.
- 1.28 Шланг силиконовый 50 см, производитель ООО «Медсиликон», Россия – 1 шт. (при необходимости)
- 1.29 Водяная ловушка на воздух – 1 шт.
- 1.30 Водяная ловушка на кислород – 1 шт.
- 1.31 Линия мониторинга давления, производитель "Интерседжикал Лтд.", Великобритания, РУ № ФСЗ 2009/03551 – 1 шт.
- 1.32 Кабель LAN 1,5м, RJ-45 – 1 шт. (при необходимости)
- 1.33 Винт M8x20.A2 DIN 7991 – 1 шт. (при необходимости)
- 1.34 Винт M8x65.A2 DIN 912 – 1 шт. (при необходимости)
- 1.35 Винт – 1 шт. (при необходимости)
- 1.36 Шайба 8.A2 DIN 9021 – 1 шт. (при необходимости)
- 1.37 Компрессор медицинский КМ с принадлежностями, варианты исполнения: КМ-24.OLD10KM, КМ-8.OLD10HK, производитель ЗАО «Ремеза», Республика Беларусь, РУ № РЗН 2018/6988 – 1 шт. (при необходимости)
- 1.38 Компрессор на тележке Voagay 10A, производитель «Шэньжэнь Прунус Медикал Ко», Китай – 1 шт. (при необходимости)
- 1.39 Пульсоксиметр медицинский «Armed», вариант исполнения YX301, производитель «Джангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд», Китай, РУ № ФСЗ 2010/07461 – 1 шт. (при необходимости)
- 1.40 Руководство по эксплуатации – 1 шт.

2. Принадлежности

- 2.1 Держатель контура WYAM010, производства WEIYE Machinery Manufacturing Co., Ltd, Китай – 1 шт. (при необходимости)
- 2.2 Комплект ЗИП согласно ведомости ИПМГ 941622.016 ЗИ в составе:
- 2.2.1 Мембрана клапана выдоха – 3 шт.
- 2.2.2 Предохранитель 2A 5*20 – 4 шт.
- 2.2.3 Ключ шестигранный DIN 911 – 2 шт.
- 2.2.4 Кольцо 023-028-30 – 3 шт.

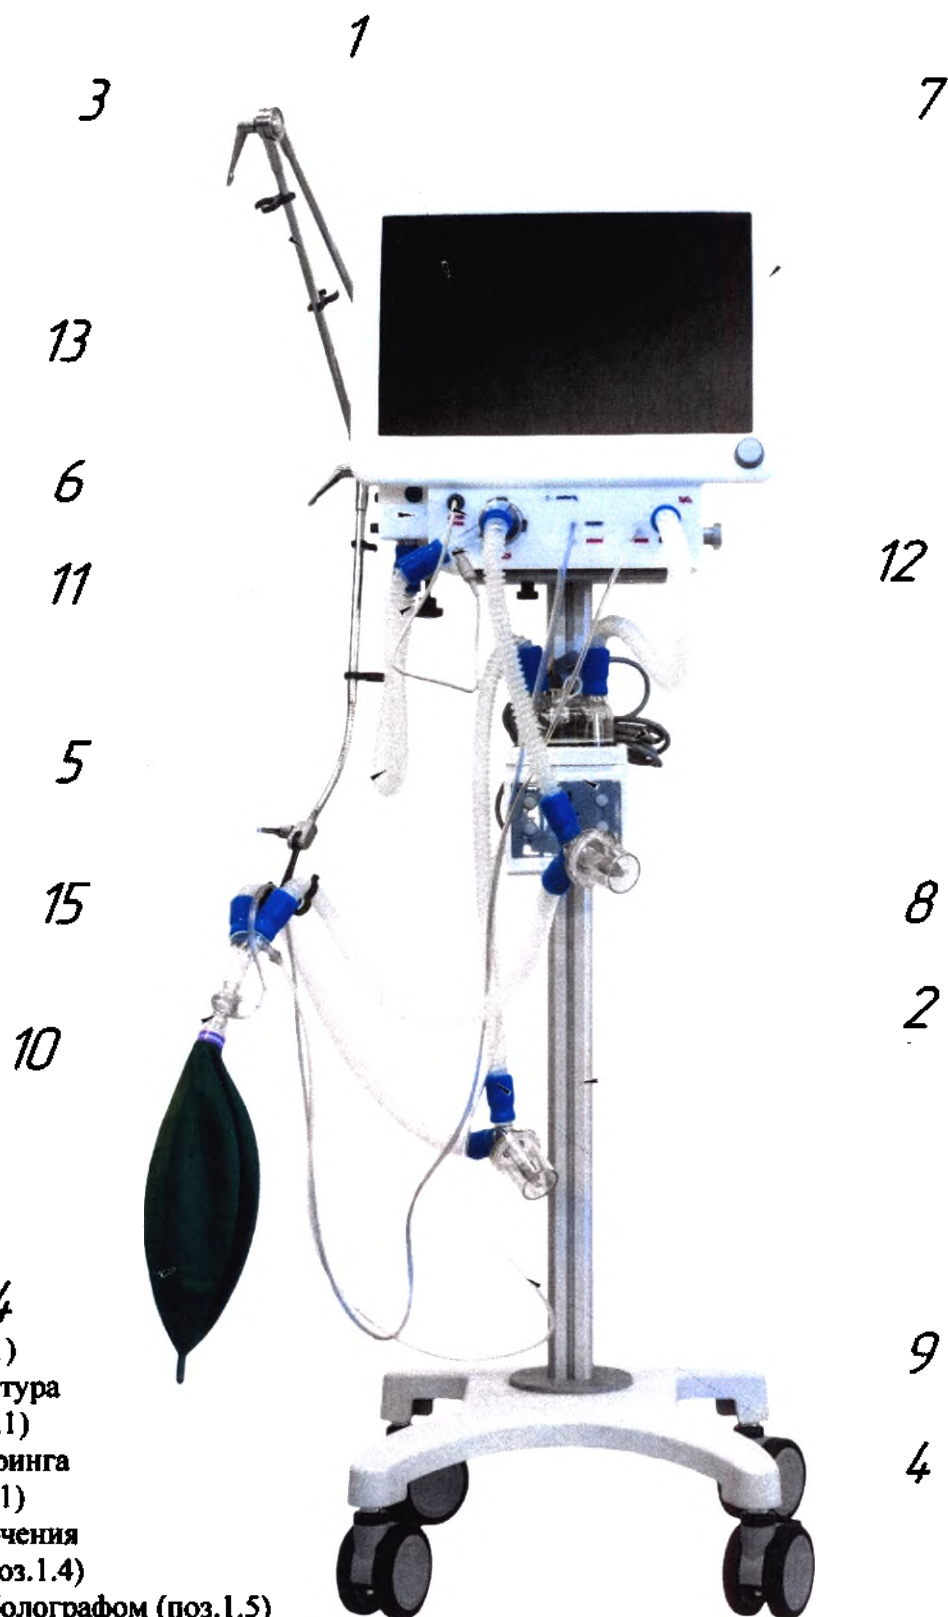

- 1 - экран 14
- 2 - стойка (поз.1.1)
- 3 - держатель контура WYAM010 (поз.2.1)
- 4 - линия мониторинга давления (поз. 1.31)
- 5 - кабель подключения датчика потока (поз.1.4)
- 6 - МКРП с метаболографом (поз.1.5)
- 7- блок ИВЛ взросло-педиатрический (поз.1.6)
- 8- увлажнитель дыхательных смесей MR850 (поз. 1.8)
- 9- комплект дыхательного контура для аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких КД-"МС-1"(поз. 1.13)
- 10 - датчик потока SpiroQuant H Flowsensor (поз. 1.18)
- 11 - датчик потока SpiroQuant A+ Flowsensor (поз. 1.17)
- 12 - шнур сетевой ПК 3x0,75 5м (поз.1.27)
- 13 - клапан выдоха (поз.1.26)
- 14 - мешок дыхательный (поз. 1.24)
- 15 - шланг силиконовый 50 см (поз.1.28)

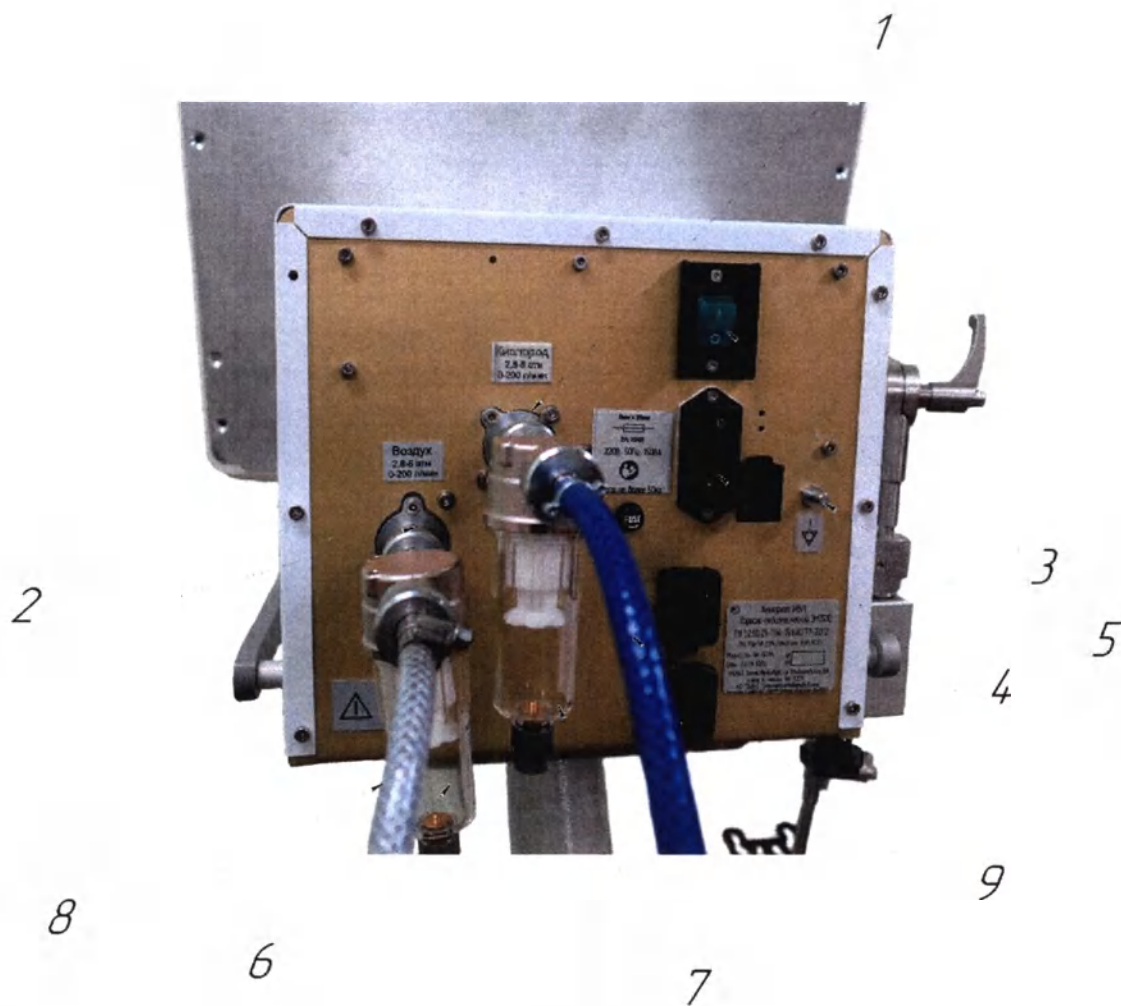

- 1 - штуцер кислорода
- 2 - штуцер воздуха
- 3 - тумблер включения
- 4 - разъем подключения питания
- 5 - заземление
- 6 - шланг воздуха (поз.1.2)
- 7 - шланг кислорода (поз.1.3)
- 8 - водяная ловушка на воздух (поз.1.29)
- 9 - водяная ловушка на кислород (поз.1.30)

9

8


3

5

7

1

6

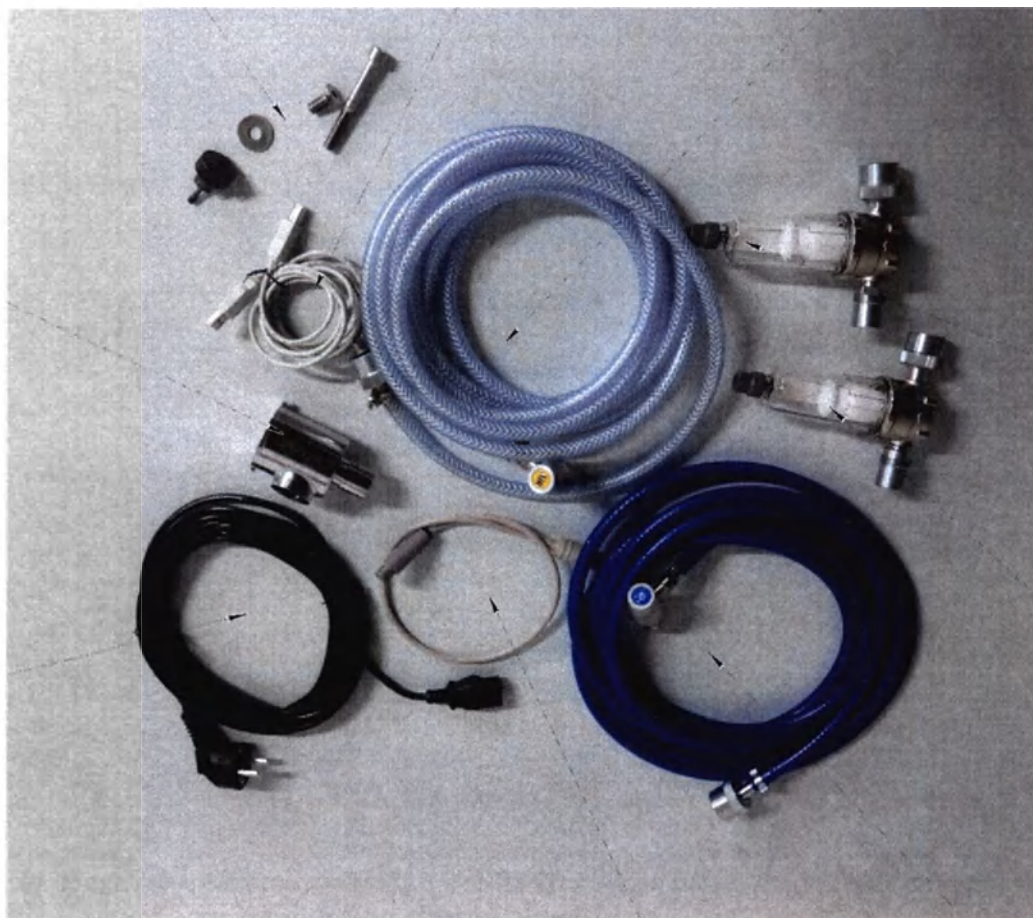

2

4

- 1 – шнур сетевой (поз.1.27)
- 2 – кабель подключения датчика потока (поз. 1.4)
- 3 – шланг воздуха (поз. 1.2)
- 4 – шланг кислорода (поз.1.3)
- 5 – клапан выдоха (поз.1.26)
- 6 – водяная ловушка на воздух (поз. 1.29)
- 7 – водяная ловушка на кислород (поз.1.30)
- 8 – кабель LAN (поз.1.32)
- 9 – винты и шайба (поз. 1.33 – 1.36)


Покупные изделия:



Увлажнитель дыхательных смесей VADI VH-2000 для аппаратов искусственной вентиляции легких с принадлежностями (поз. 1.9, 1.9.1)




Увлажнитель дыхательных смесей ТЕВЛАР – «УОМЗ» (поз. 1.10.1-1.10.3)

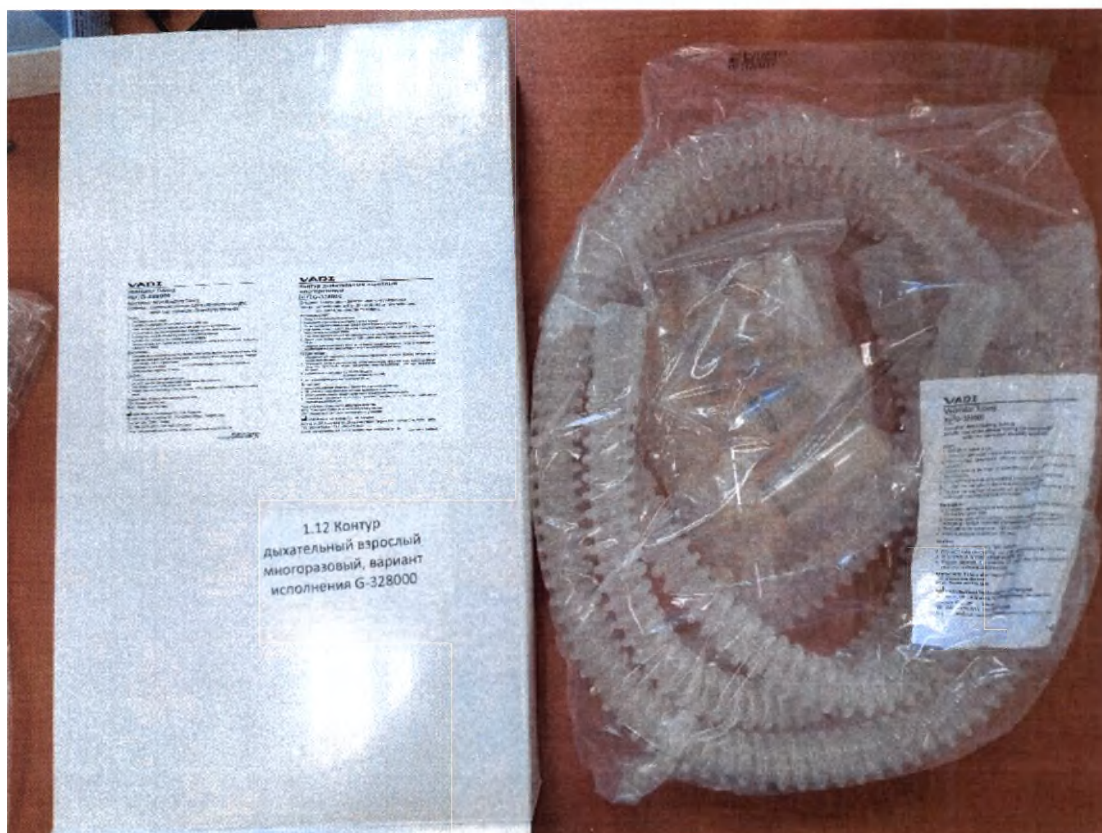

Контур дыхательный взрослый многоразовый, вариант исполнения G-328000 (поз.1.11)



Контур дыхательный взрослый одноразовый, вариант исполнения G-316001 или G-316001-1 (поз.1.12)

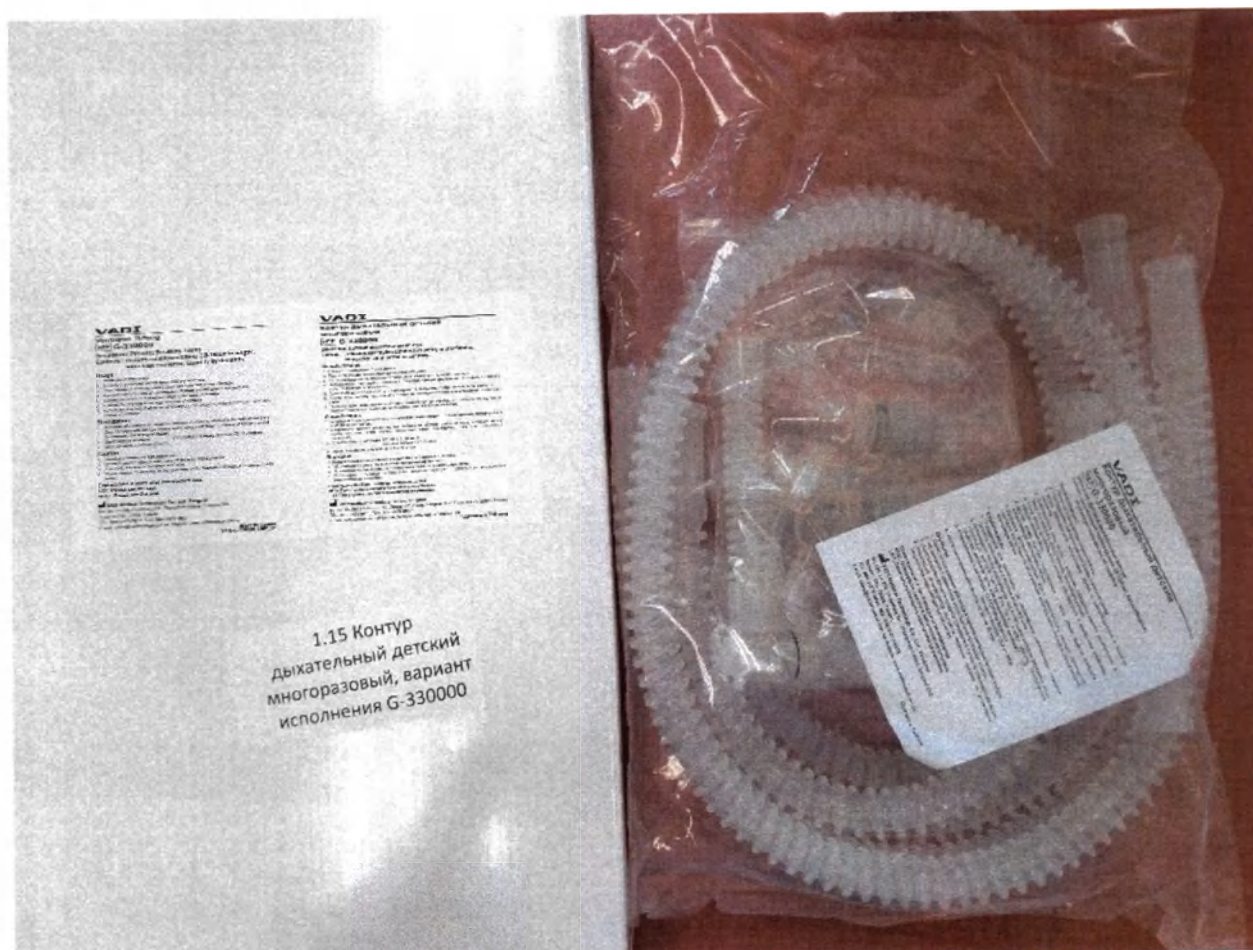

1.15 Контур
Дыхательный детский
многоразовый, вариант
исполнения G-330000


Контур дыхательный детский многоразовый, вариант исполнения G-330000 (поз.1.14)



Контур дыхательный (поз. 1.15)



Небулайзер Aeroneb Pro (поз. 1.16)

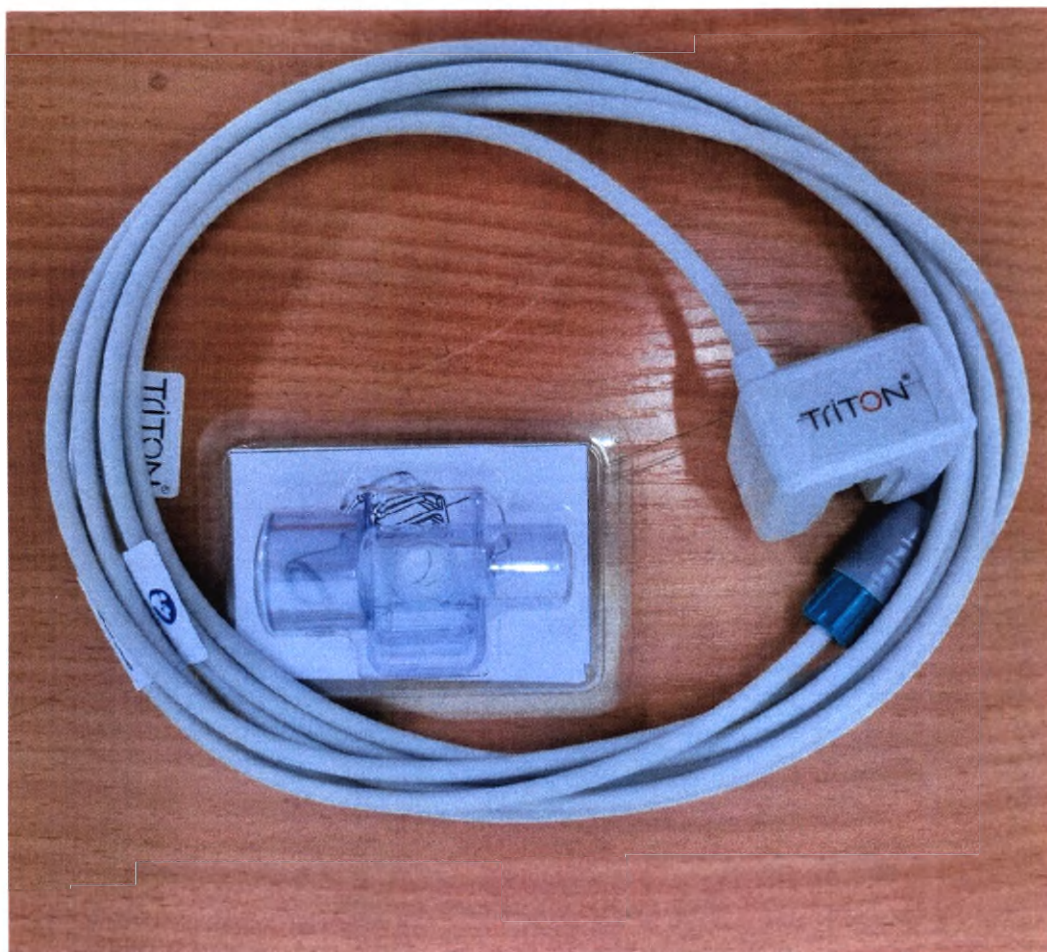

Модуль газоанализа дыхательной смеси (без отбора пробы) (поз. 1.19.1-1.19.3)



Фильтр электростатический (поз. 1.20)



Маска, размер 5 (поз.1.21)



Маска, размер 4 (поз.1.22)



Маска, размер 3 (поз.1.23)



Коннектор (поз. 1.25)



Компрессор медицинский КМ с принадлежностями (поз. 1.37)




Компрессор на тележке Boaray 10A (поз. 1.38)



Пульсоксиметр медицинский «Armed», вариант исполнения YX301 (поз.1.39)

Принадлежности

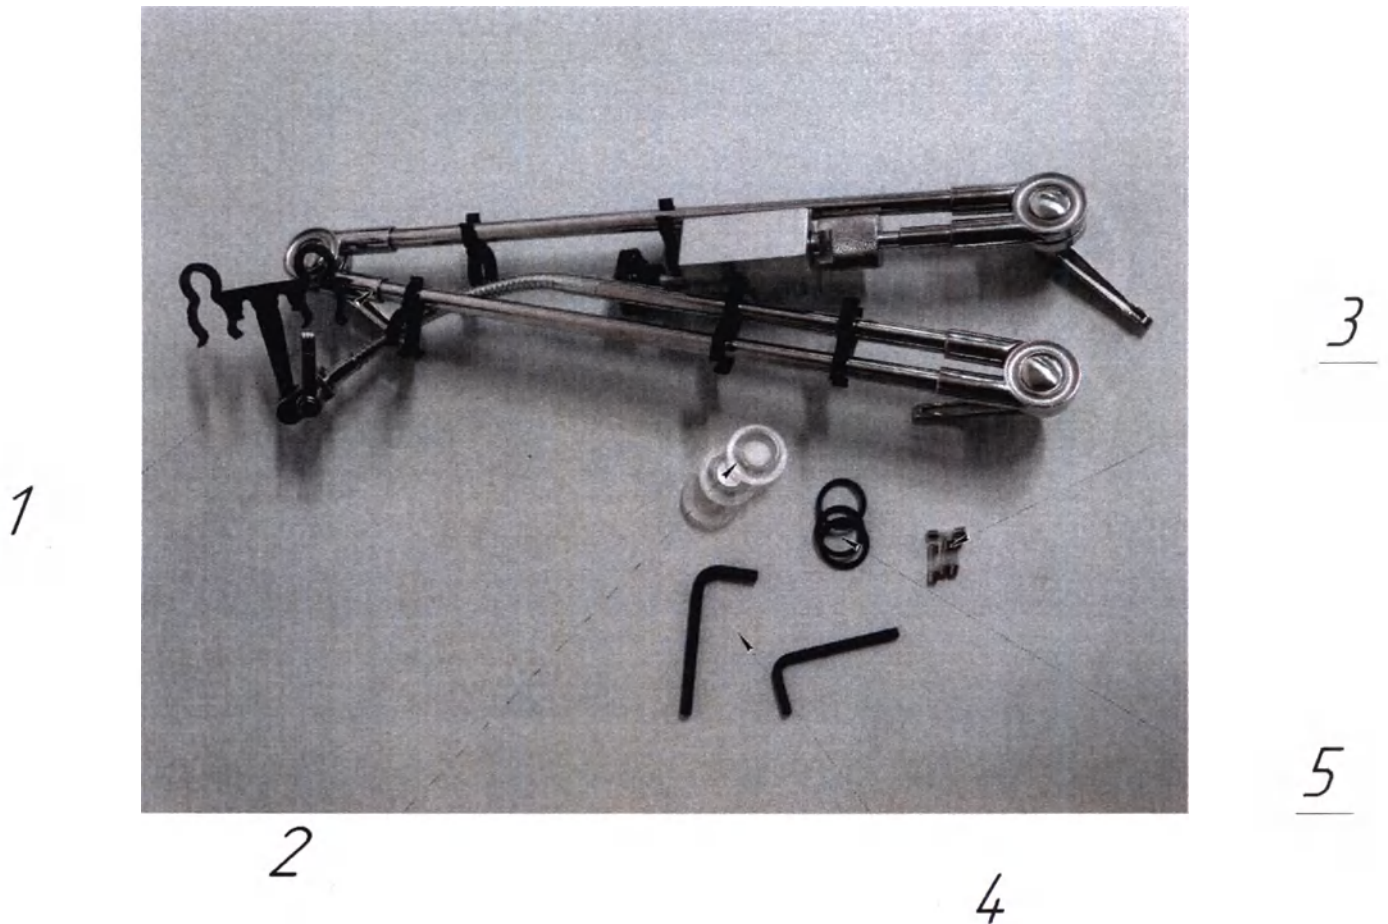

- 1 – держатель контура WYAM010 (поз. 2.1)
- 2 – мембрана клапана выдоха (поз. 2.2.1)
- 3 – предохранитель (поз. 2.2.2)
- 4 – ключи шестигранные DIN 911 (поз.2.2.3)
- 5 – кольцо (поз. 2.2.4)

Маркировка на изделии



Транспортная упаковка



Генеральный директор

Малкин Я.М.



