

**Генеральный директор
ООО "Ювент Компани"**



Николайчев А.Л.

«20» сентября 2021г.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с низкой пропускной способностью (LPS), модель: LPS 100



ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСЗ 2010/07032 от 25.05.2010

ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЛЯРНОЕ ВОЛОКНО С ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ: ПОЛИСУЛЬФОН: М - НИЗКАЯ, РМ - СРЕДНЯЯ, РН - ВЫСОКАЯ

ПОЛИСУЛЬФОН: LPS - НИЗКАЯ, LPS - ВЫСОКАЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Открытая, особая форма упаковки. Примените медицинское изделие по назначению врача. Вскрытие упаковки и применение медицинского изделия. Убедитесь, что предостережения после вскрытия упаковки и назначения медицинского изделия не являются противопоказанием. Проверьте инструкцию перед применением! и следите за соблюдением всех правил.

НЕ ПЕРЕКРАШИВАЙТЕ ИЛИ НАРУШАЙТЕ

НЕ ПОСКОБЯЧИТЕ ИЛИ ПОВРЕЖДАЙТЕ ДИСКУС УПАКОВКИ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ/ЭКСПЛУАТАЦИИ: при температуре от 6°C до +36°C.

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ОТ 60 ДО 80%.

АБСОЛЮТНО НЕТОКСИЧНО (Sterile) для однократного применения.

Использовать метод стерилизации:

ЕО - ЭТИЛЕНОКСИД, Р - РАДИКАЦИОННЫЙ МЕТОД.

Внимание! При использовании изделия в соответствии с инструкцией по применению, пожалуйста, соблюдайте все меры предосторожности, указанные в инструкции по применению. Не используйте изделие, если оно повреждено или если срок годности истек. Не используйте изделие, если оно не соответствует требованиям, указанным в инструкции по применению.

Эторопал

Применяется: Амбулаторное устройство "Эторопал" ("Эторопал" АДЛ, Болгария). Адрес и контактные данные: Болгария, гр. Етрополе, област София, бул. Руски № 191, България тел: +359 720 63422, факс: +359 720 67096, office@etoropal.eu, www.etoropal.eu

Место производства медицинского изделия: "Эторопал" АДЛ, 2180, Болгария, гр. Етрополе, област София, бул. Руски № 191

Уполномоченная представлять в Российской Федерации: ООО «Эторопал Компани», 125367, Российская Федерация, г. Москва, Псковский проезд д.10 стропение 1, 2 этаж, контактный телефон: 8-495-645-55-66, 8-985-885-88-88, e-mail: uven@etoropal.com, info@etoropal.com сайт: www.etoropal.com


ЮВЕНТ

С 06021
2024.08
CE 2195
3 600072 409758
STERILE
Etropal JSC, Ruski blv 191, 2180 Etropole, Bulgaria
BLOOD OUTLET

Модель: LPS 100
Метод стерилизации: Р
С 06021
2021.08
2021.08
2024.08


3 600072 409758

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с низкой пропускной способностью (LPS), модель: LPS 110

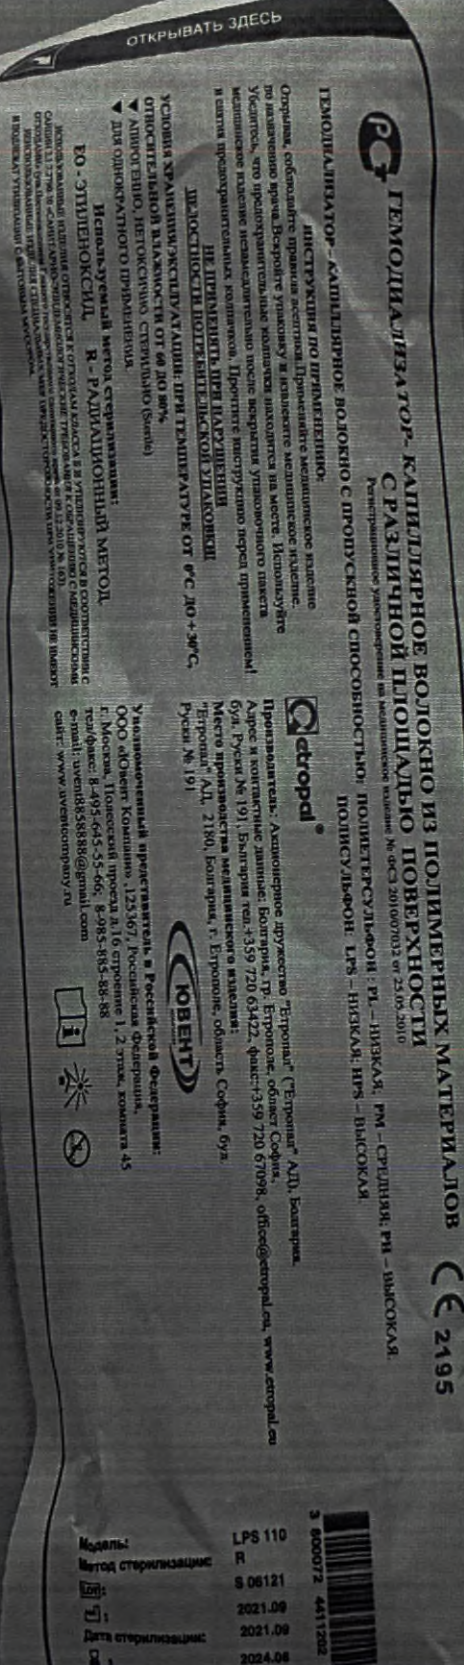


Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с низкой пропускной способностью (LPS), модель: LPS 130

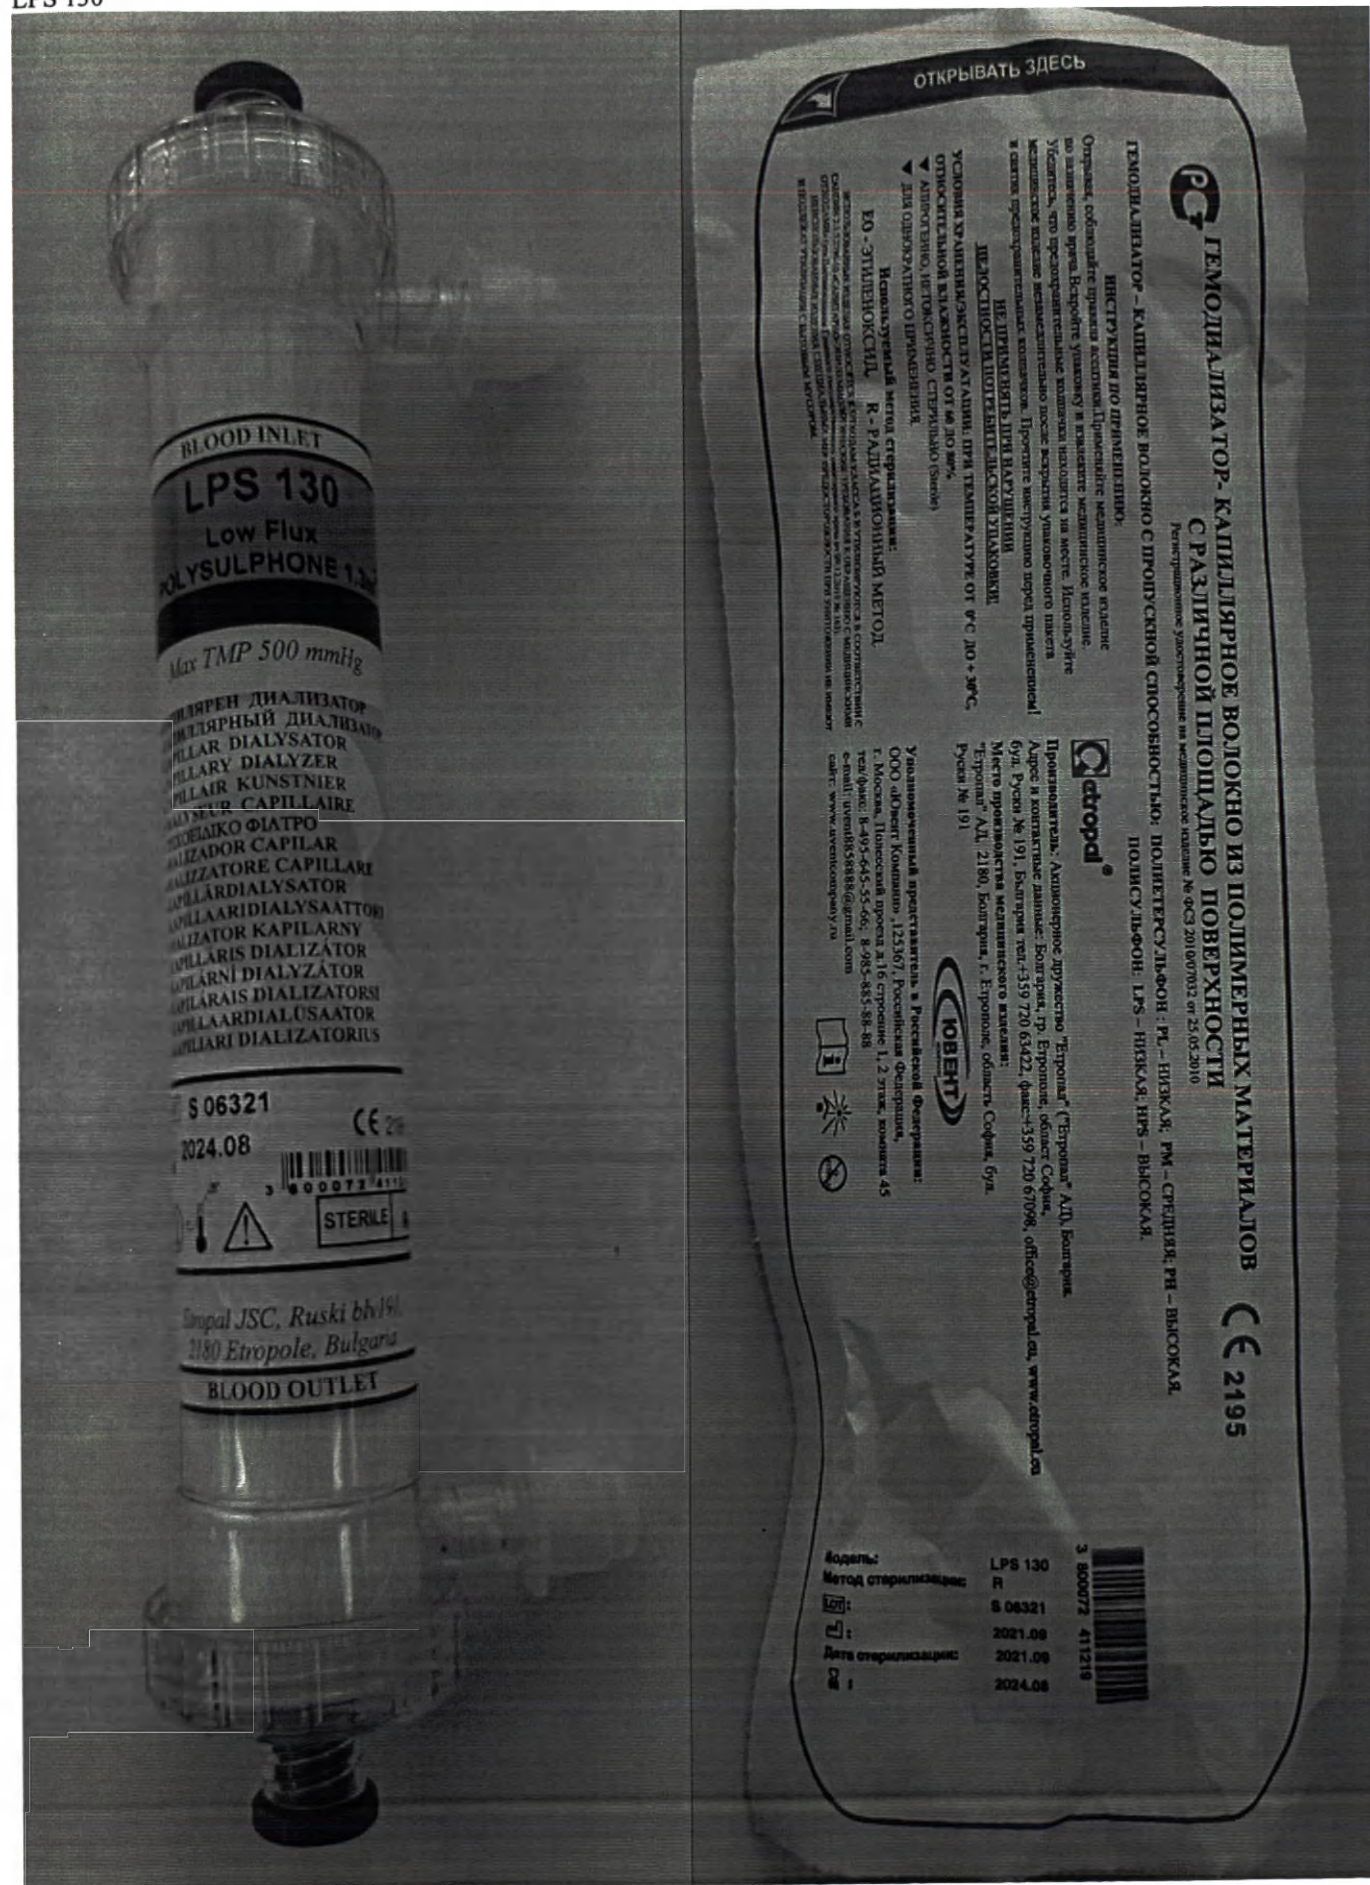

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с низкой пропускной способностью (LPS), модель: LPS 140

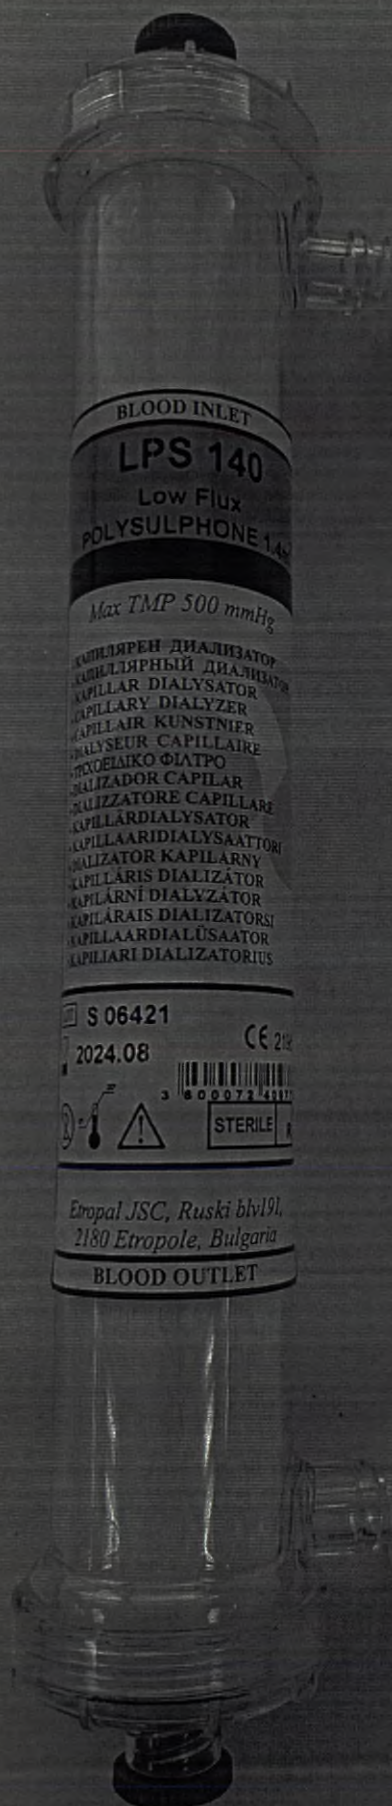

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ № 063 2010/07021 от 25.05.2010

ПОЛИСУЛЬФОН: LPS - НИЗКАЯ, HPS - ВЫСОКАЯ

CE 2195

ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЛЯРНОЕ ВОЛОКНО С НИЗКОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Открытая, свободная от протекания жидкостей. Примените медицинское изделие по назначению врача. Вскрытие упаковки и извлечение медицинского изделия. Убедитесь, что предохранительные крышки полностью извлечены из места. Используйте медицинское изделие немедленно после вскрытия упаковки. Не используйте изделие в целях предохранительных контейнера. Прочтите инструкцию перед применением.

НЕ ПЕРЕМЕШАЙТЕ ПРЕДУПАЖЕНИЯ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОКИ ГОДАШНИ: при температуре от 0°C до +30°C.

ОТВОСЛЮЖАЮЩАЯ ВЛАЖНОСТЬ ОТ 60 ДО 80%.

АДВОСЛЮЖАЮЩАЯ ВЛАЖНОСТЬ СТЕРИЛЬНО (Sterile)

ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Неиспользуемый метод стерилизации:

EtO - этиленоксид, R - радиационный метод.

ВНИМАНИЕ! Не использовать изделие после истечения срока годности, указанного на упаковке. Не использовать изделие после истечения срока годности, указанного на упаковке. Не использовать изделие после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Etropal

Производитель: Акционерное общество "Европал" АД, Болгария.

Адрес и контактные данные: Болгария, гр. Етрополе, община София, б-д. Руски бл. 191, България тел: +359 720 63422, факс: +359 720 67098, office@etropal.bg, www.etropal.bg

Место производства медицинского изделия:

"Европал" АД, 2180, Болгария, гр. Етрополе, община София, б-д. Руски бл. 191

Уполномоченный представитель в Российской Федерации:

ООО «Ювент Компани», 125367, Российская Федерация, г. Москва, Полесский проезд д.16 строение 1, 2 этаж, комната 45

Тел/факс: 8-495-645-55-66; 8-985-885-88-88

E-mail: juvent85888@yandex.ru

сайт: www.juventcompany.ru

Модель: LPS 140

Метод стерилизации: R

Идентификация: S 06421

Дата стерилизации: 2021.08


Идентификация: 2021.08

Дата стерилизации: 2024.08

3 800072 409773


Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с низкой пропускной способностью (LPS), модель: LPS 150

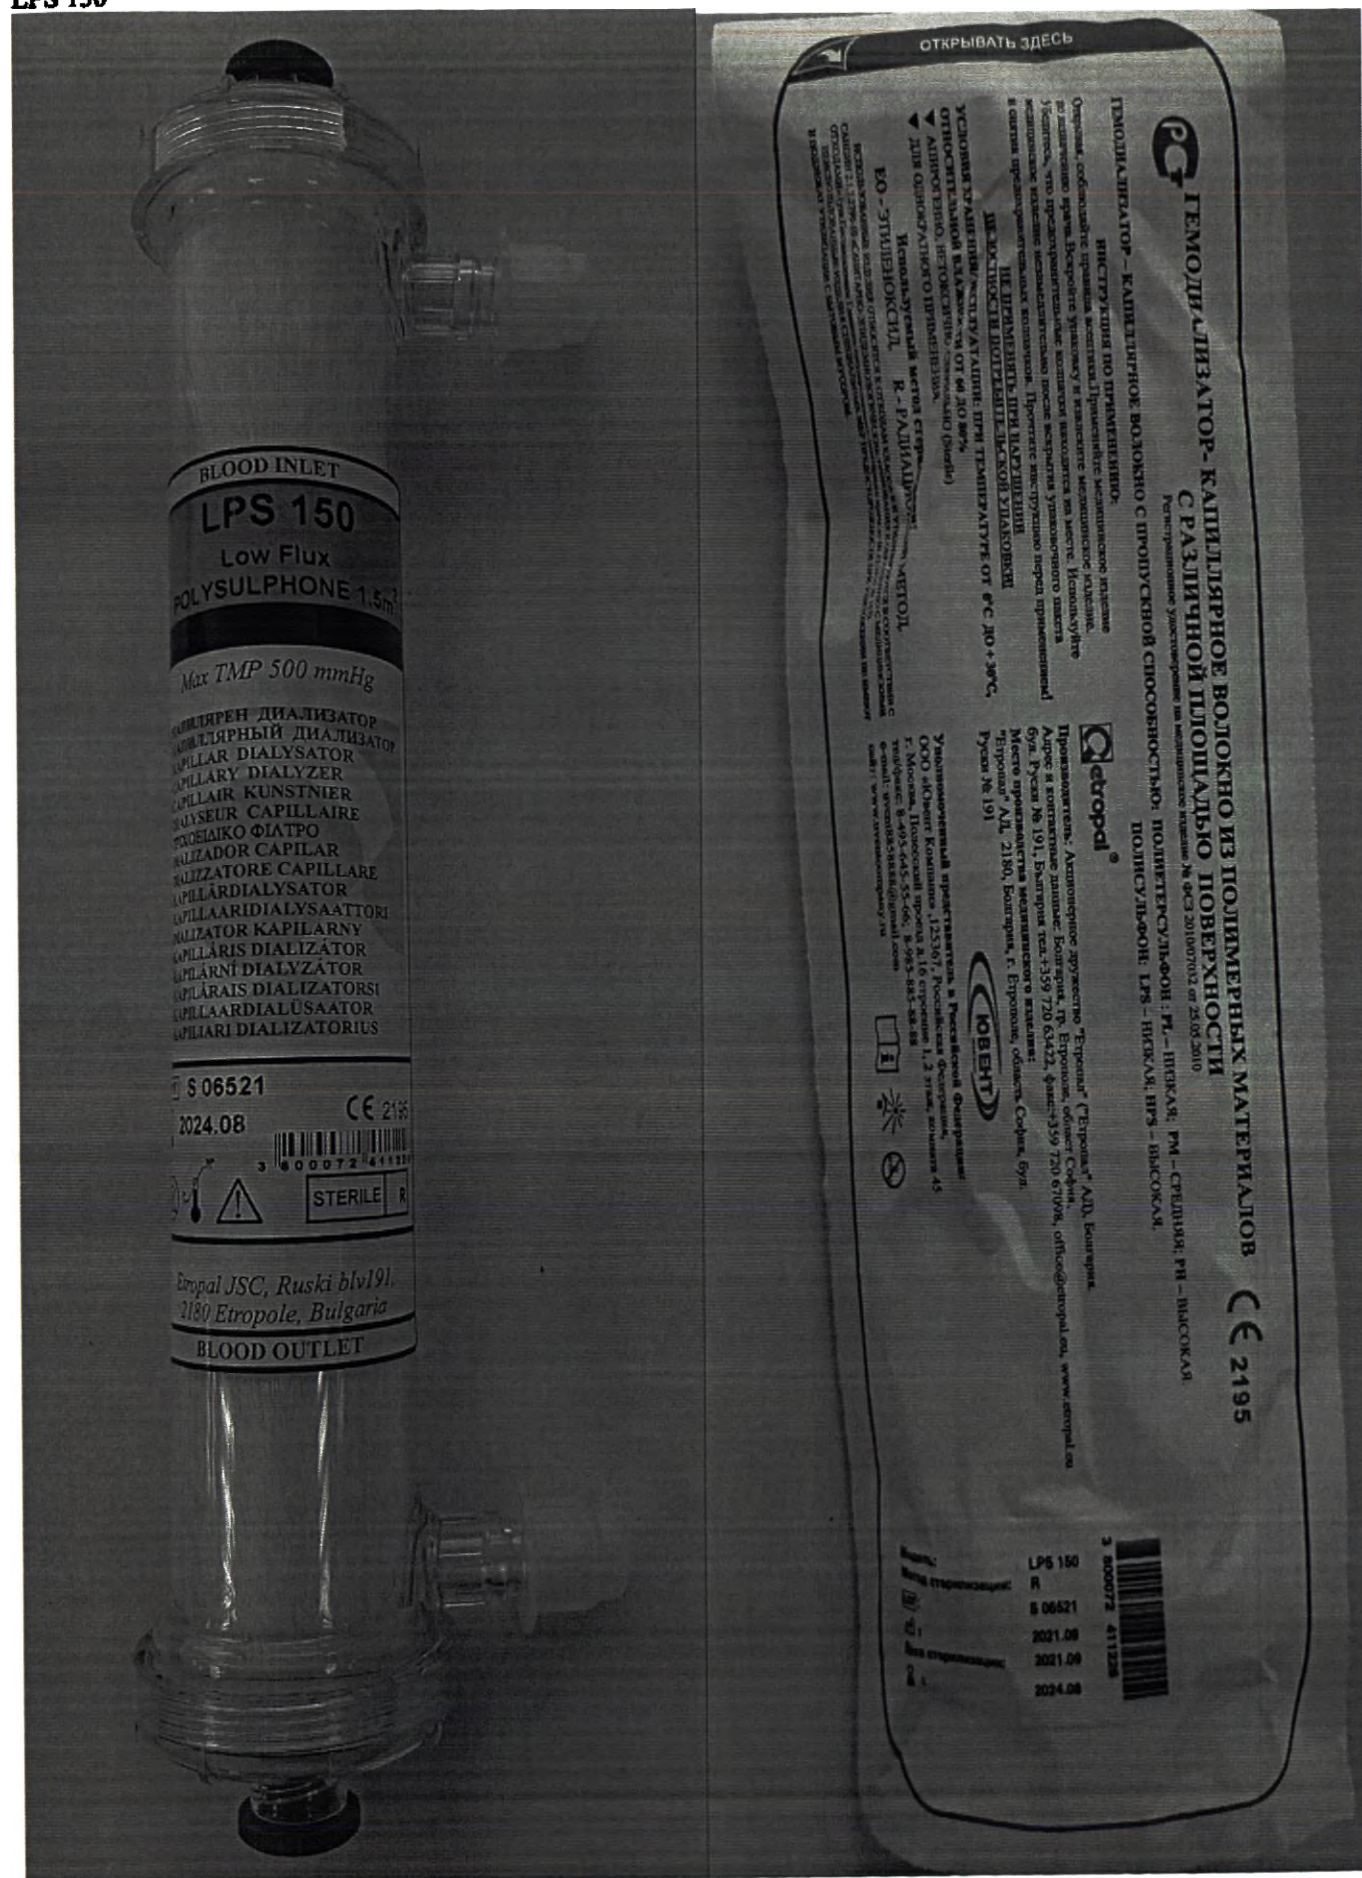


Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с низкой пропускной способностью (LPS), модель: LPS 160

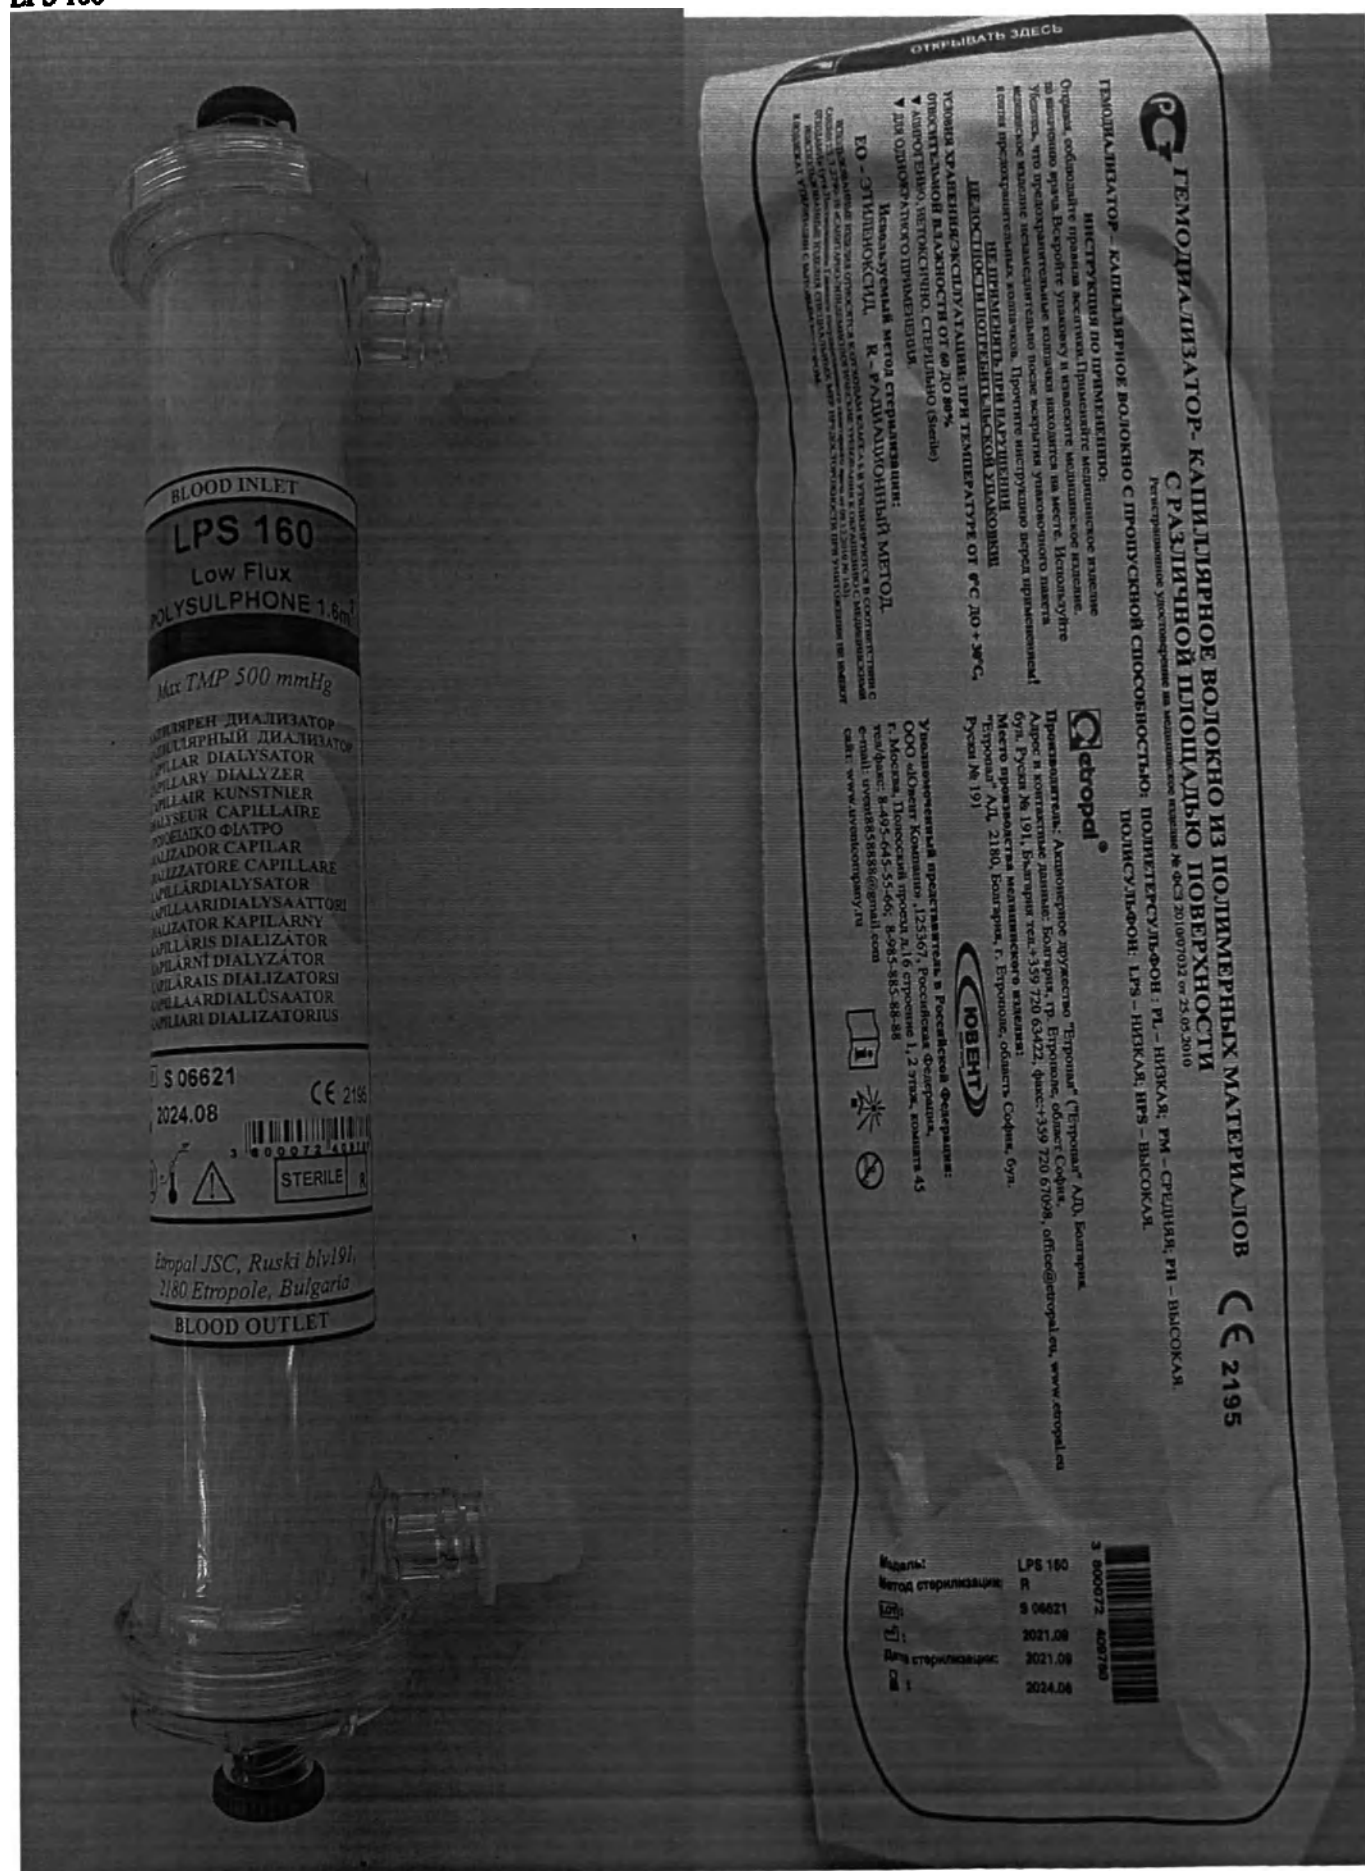


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с низкой пропускной способностью (LPS), модель: LPS 170

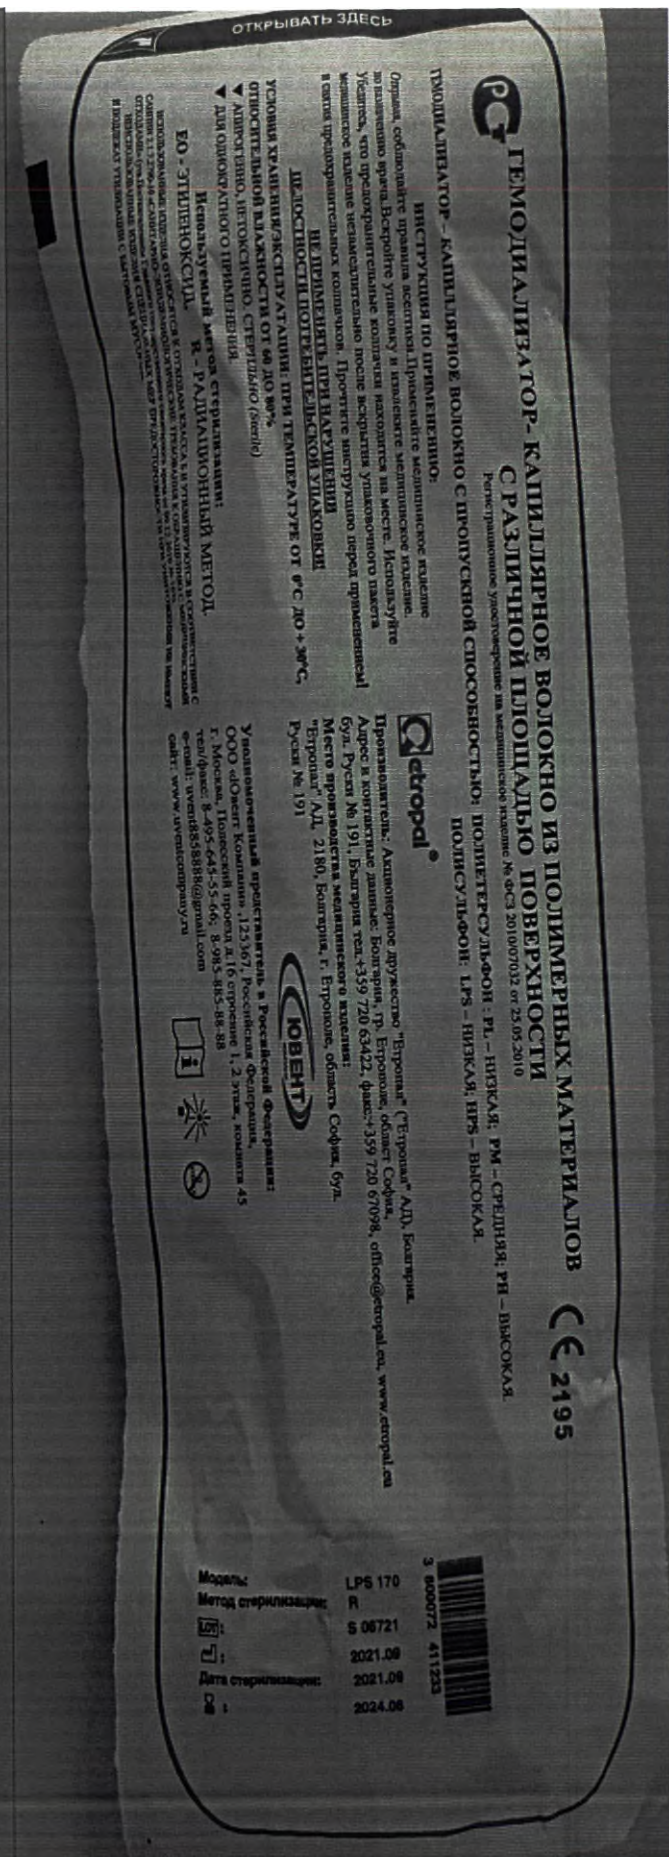


Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с низкой пропускной способностью (LPS), модель: LPS 190

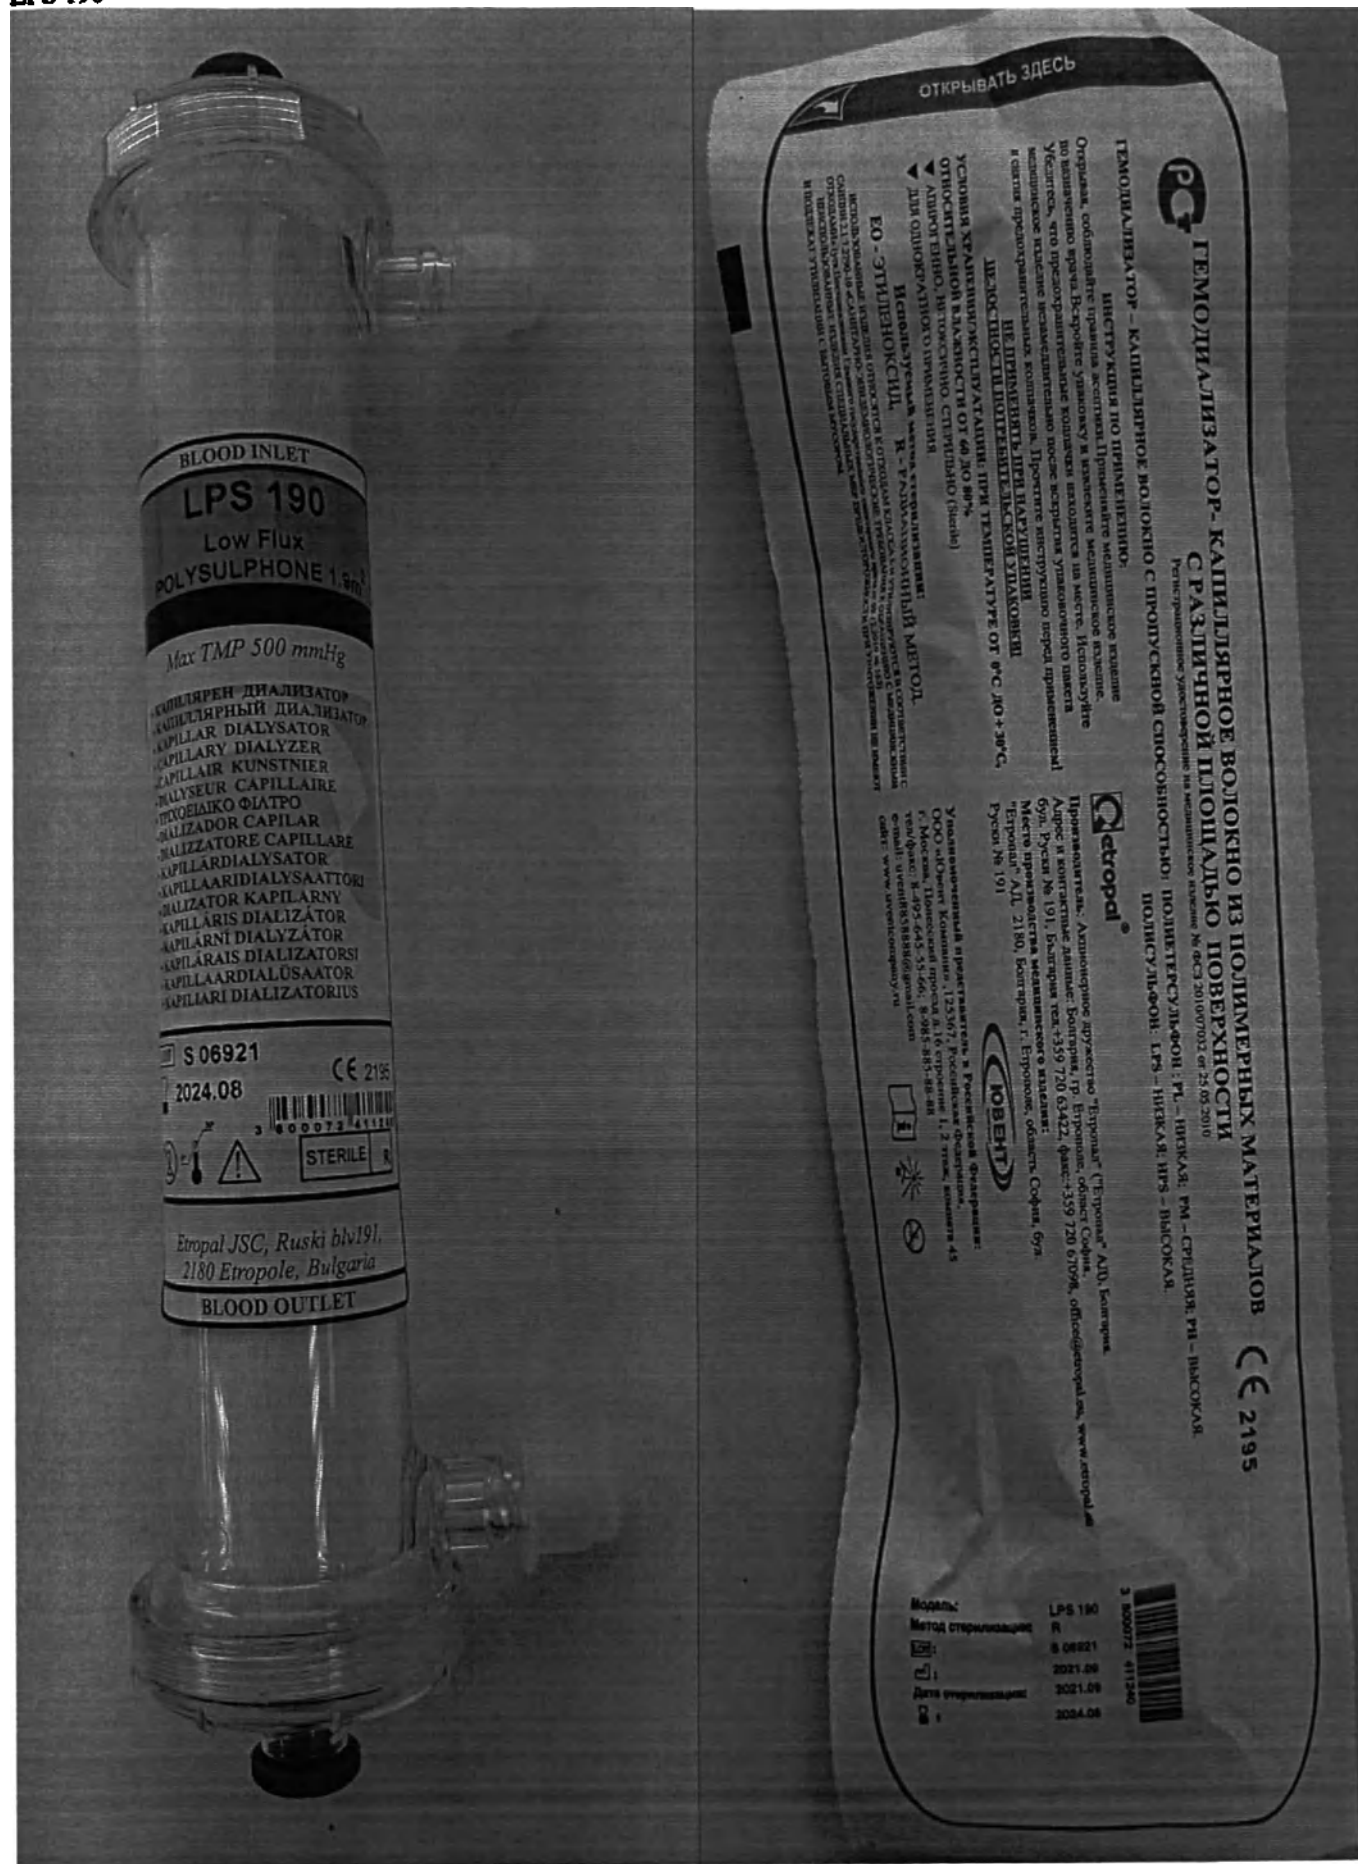

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:
Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с низкой пропускной способностью (LPS), модель: LPS 200

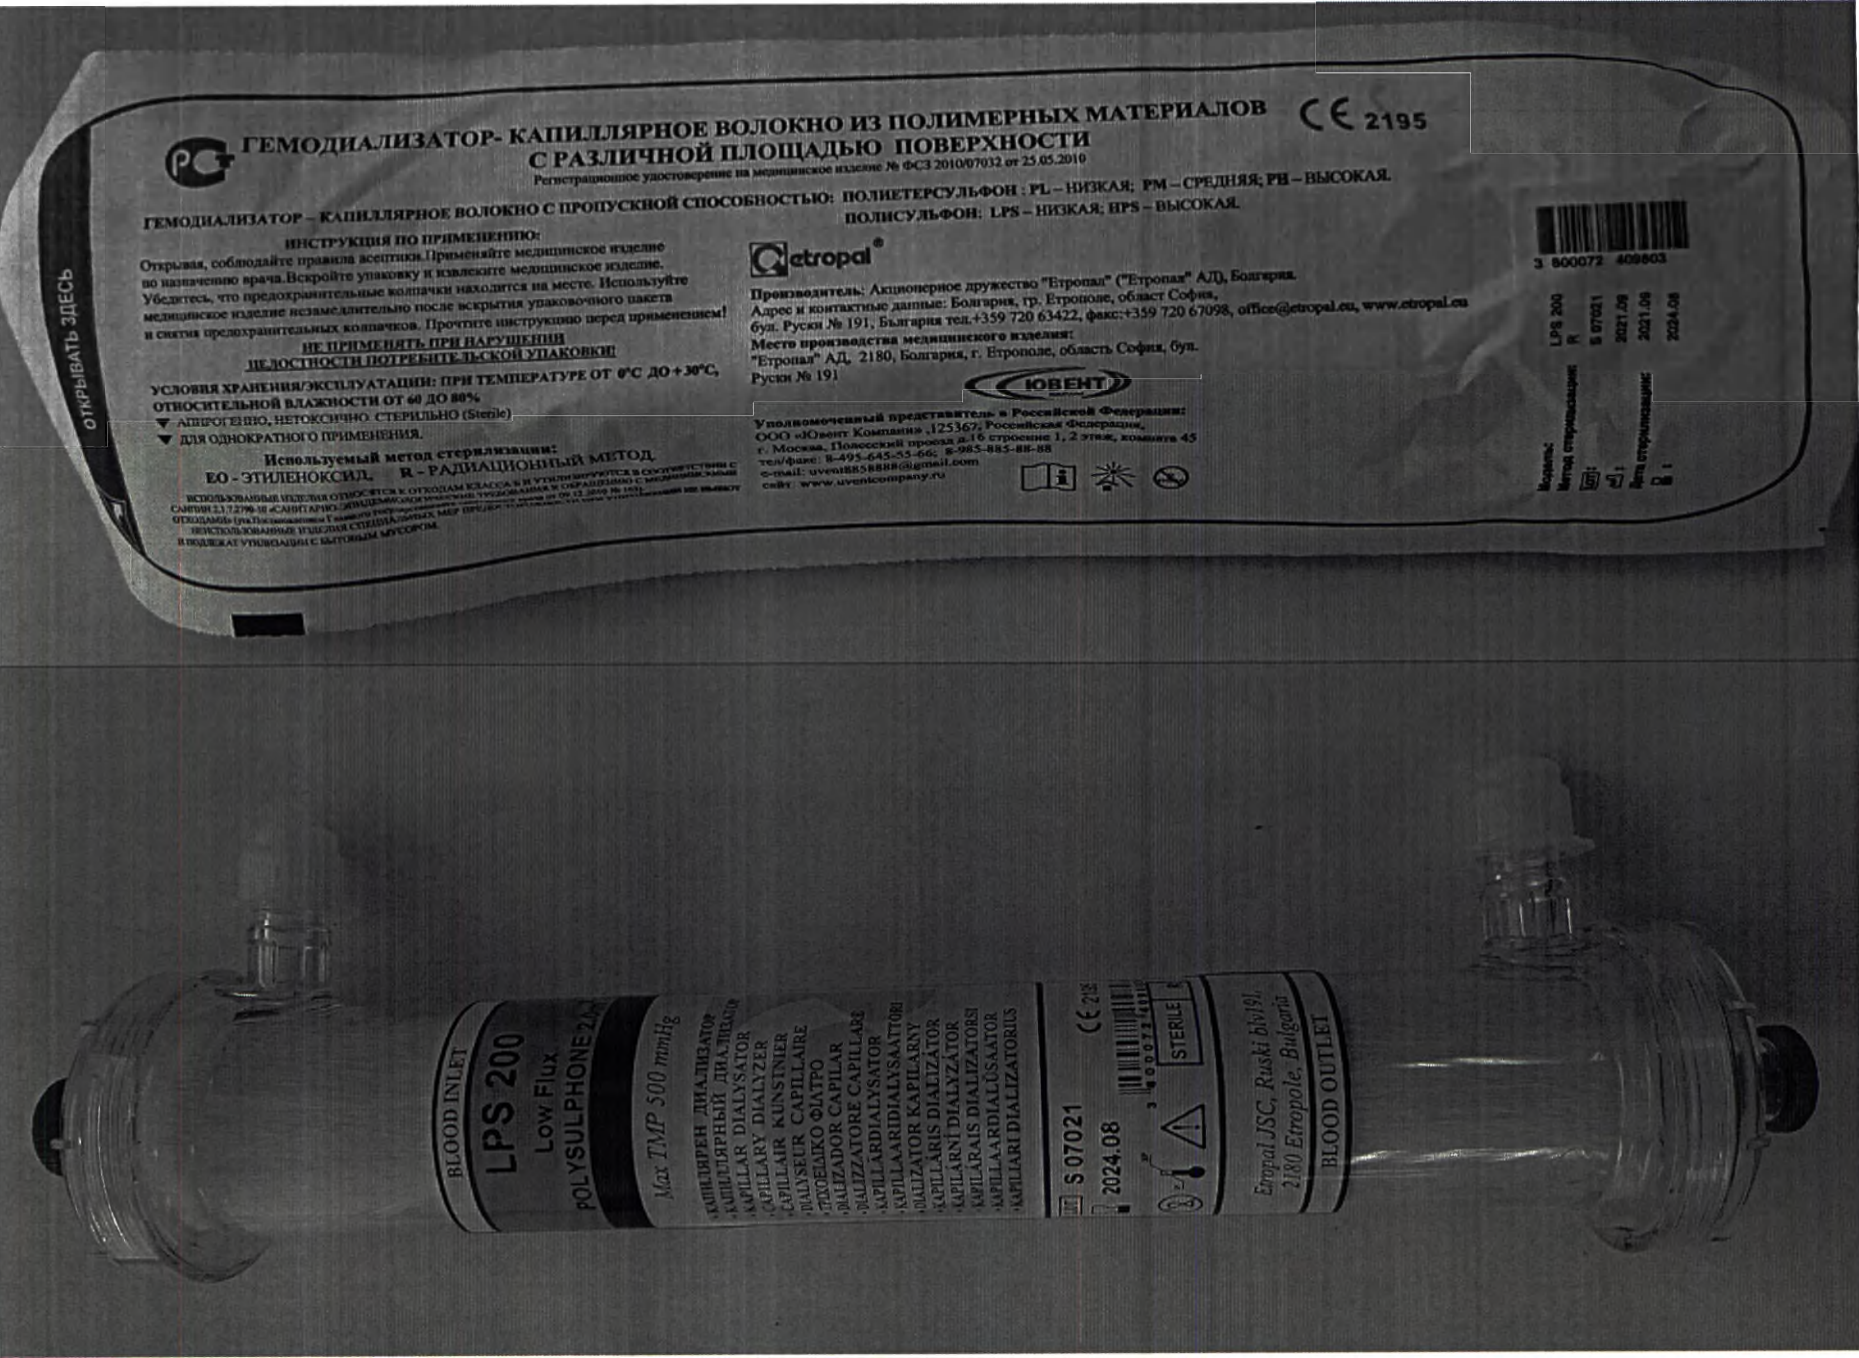

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с низкой пропускной способностью (LPS), модель: LPS 210

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



ТЕМОДИЛИЗАТОР-КАПИЛЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

с РАЗЛИЧНОЙ ПОСКОРОНОСТЬЮ. Репетиционное ускорение на магнитном секторе № ФЭЗ 2010/03.02 от 25.03.2010

[illegible]

CC 2195

ГМОДНАЛНАТОР - КАДРОВИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ПЕЛЕНА

НЕ ПРЯВАЙТЕСЬ ПРИ НАРУШЕНИИ

THE PRESENTED DATA ON THE
SOCIAL MOTIVATION OF THE
CIVILIAN POPULATION OF THE
CITY OF MOSCOW

ИД.НОСТРОИТЕЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ПРИ ТЕХНИКАТЪЕ OF 0 C. 20 + 30 C.

относительной влажности от 60 до 90 %


[illegible]

ИСПОЛЪЗВАНЕ НА
БЕ-ПАЗИТЕЛНИ
ЕО - ЭТИЛЕНОВИД.

INTERNATIONAL JOURNAL OF

[illegible]

Университетский пресептатель в России действует
ООО «Юлтех Коммунити» 125367, Россия/Москва/Сити-центр
г. Москва, Давыдовский проезд д.16 стропило 1, 2-й этаж, комната 45
т/ф/факс: 8-(495)-645-55-66; B-9145-885-88-18
e-mail: svetlana.5181882@gmail.com
сайт: www.davidsociety.ru

[illegible]



3 800072 411257

LPS 210
R
S 07121
2021.00
2021.00
2024.00

Метод стерилизации: автоклавирование

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с низкой пропускной способностью (LPS), модель: LPS 230

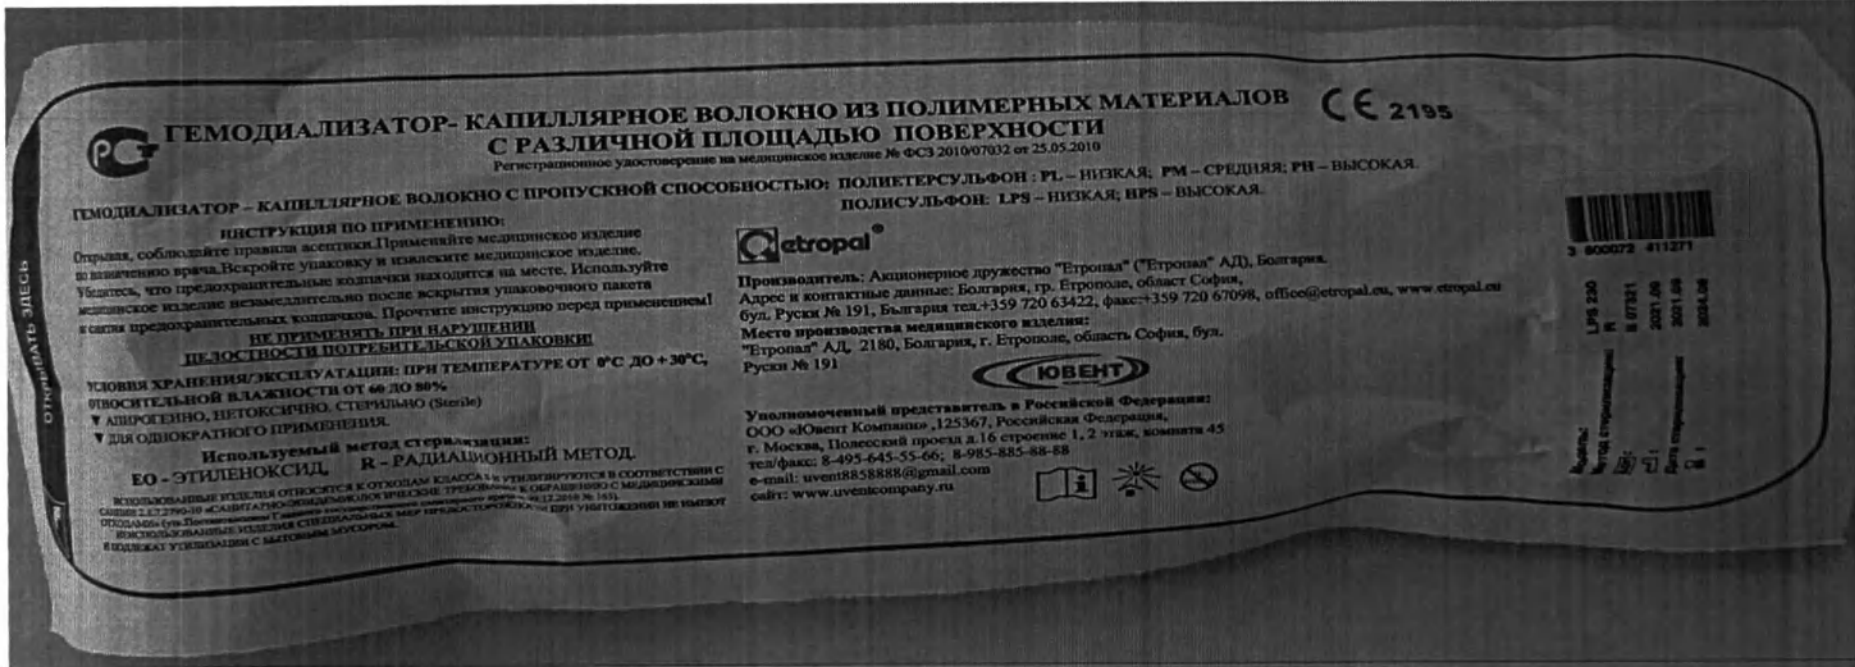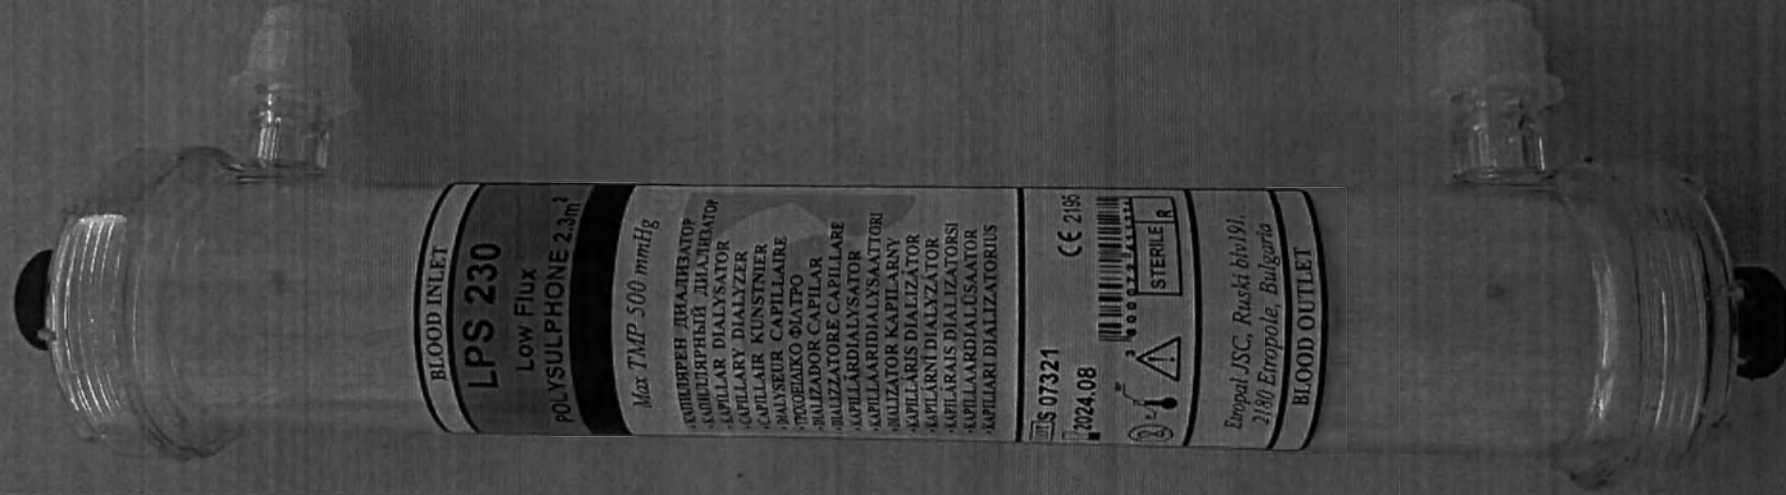

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с низкой пропускной способностью (LPS), модель: LPS 240



BLOOD INLET
LPS 240
 Low Flux
 POLYSULPHONE 2.4m²
 Max TMP 500 mmHg

КАПИЛЯРЕН ДИАЛИЗАТОР
 КАПИЛЯРНЫЙ ДИАЛИЗАТОР
 KAPILLAR DIALYSATOR
 CAPILLARY DIALYZER
 CAPILLAIR KUNSTNIER
 DIALYSEUR CAPILLAIRE
 ΤΡΙΧΟΕΛΙΚΟ ΦΙΑΤΡΟ
 DIALIZADOR CAPILAR
 DIALIZZATORE CAPILLARE
 KAPILLÄRDIALYSATOR
 KAPILLAARIDIALYSAATTORI
 DIALIZATOR KAPILARNY
 KAPILLÄRIS DIALIZÄTOR
 KAPILÄRNI DIALYZÄTOR
 KAPILÄRAIS DIALIZATORSI
 KAPILLÄRDIALÜSAATOR
 KAPILIARI DIALIZATORIS

LOT S 07421
 2024.08
 CE 2195
 STERILE R

Etropal JSC, Ruski blv191,
 2180 Etropole, Bulgaria

BLOOD OUTLET

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ КЛАССЕ № ФСЗ 2010/07032 от 25.05.2010

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Открытая, свободная правая асептика. Проведите медицинское изделие по назначению врача. Вскройте упаковку и извлеките медицинское изделие. Убедитесь, что предохранительные колпачки находятся на месте. Используйте медицинское изделие незамедлительно после вскрытия упаковочного пакета и снятия предохранительных колпачков. Прочтите инструкцию перед применением.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ПРОТЯЖИТЕЛЬНОЙ ЗАКОНОВЫЙ


УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: ХРАНЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 0°С ДО +30°С, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ОТ 60% ДО 80%.

▲ АПТЕЧНОЕ, ГОМОЛОГИРОВАННОЕ, СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ

▲ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Неиспользуемый метод стерилизации: R - РАДИОАКТИВНЫЙ МЕТОД.

ЕО - ЭТИЛЕНОКСИД. ВНИМАНИЕ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ К ПОЛЬЗОВАНИЮ С ГЕМОДИАЛИЗАТОРОМ. НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ГЕМОДИАЛИЗАТОРОМ, ЕСЛИ НА НЕГО ПОПАЛИ ЛИШЬ, ПОСЛЕДСТВИЕМ ЧЕГО МОЖЕТ ПРОИЗВЕСТИСЯ ПОСЛЕДСТВИЕМ НА ВЫХОДЕ ИЗДЕЛИЯ УВЕЛИЧЕНИИ С ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ.



Производитель: Актинтерное предприятие "Етропол" ("Етропол" АДЛ, Болгария. Адрес и контактные данные: Болгария, гр. Етрополе, област София, бул. Руски № 191. Контакт тел: +359 720 63422, факс: +359 720 67094, office@etropal.bg, www.etropal.bg. Место производства медицинского изделия: "Етропол" АДЛ 2180, Болгария, гр. Етрополе, област София, бул. Руски № 191




Уполномоченный представлять в Российской Федерации: ООО «Ювент Компани», 125167, Российская Федерация, г. Москва, Псковский проезд, д. 16, строение 1, 2 этаж, комната 45 тел/факс: +7 495-645-55-66, 8-800-885-88-88 e-mail: info@juvent.com сайт: www.juventcompany.ru



Модель: LPS 240
 Метод стерилизации: R
 Актинтерное предприятие: S 07421
 Дата изготовления: 2021.09
 Дата окончания срока годности: 2024.09

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с низкой пропускной способностью (LPS), модель: LPS 250

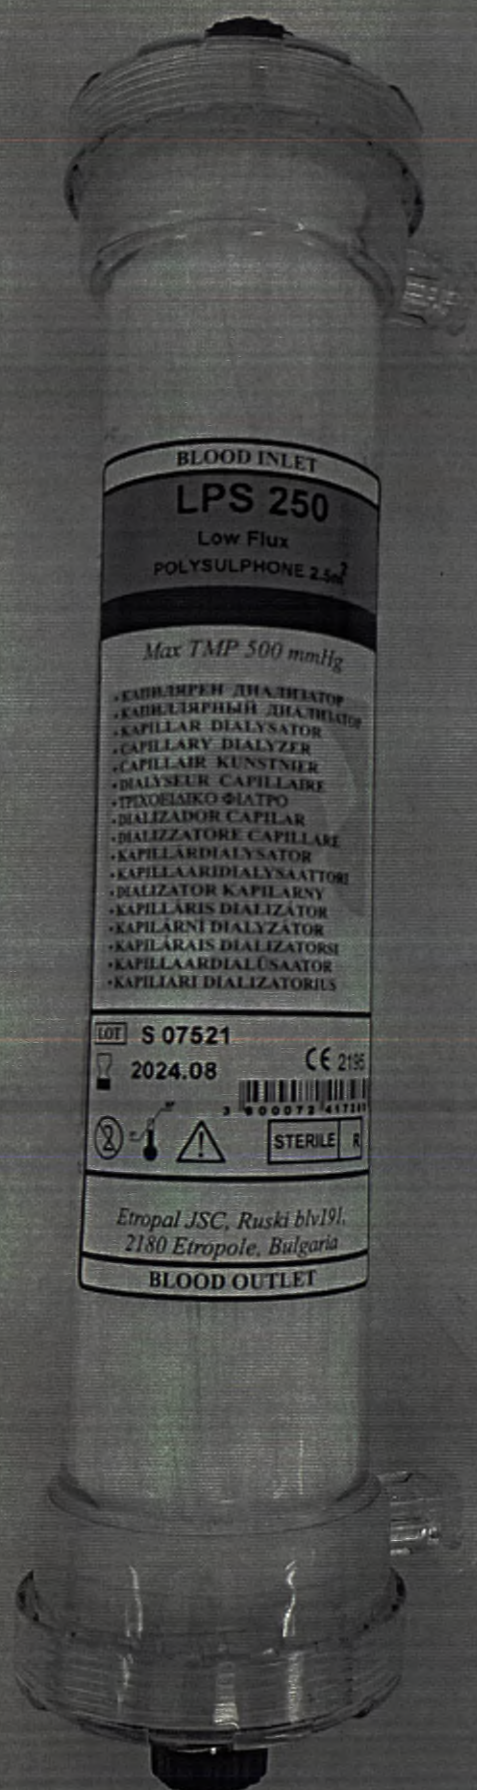

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



**ТЕМОДИАЛИЗАТОР-КАПИЛЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ**

CC 2195

ТЕМОДИАКТИВНОСТЬ — КОЭФФИЦИЕНТ

Организм, воспринимая принцип селективности при приеме молекулярного препарата по назначению врача, безразлично, какого он происхождения по происхождению. Убедитесь, что препаративные компоненты находятся на месте. Необходимо учитывать, что препаративные компоненты после вскрытия упаковки могут измениться. Избегайте использования препарата после истечения срока годности. В случае необходимости проконсультируйтесь с врачом. Препараты, содержащие компоненты, могут быть использованы для лечения заболеваний.

...COSTA/ATLANTIC: 1991

ОТНОСИТЕЛНИОН ИЗМЕНЕНИЕ

► PER INFORMAZIONI

ЭКОНОМИКА

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

THE BELL & HOWELL
PUBLISHING COMPANY
ANN ARBOR, MICHIGAN 48106

1

10

1

Университетский интернет-портал «Российский Физкультура»
 ООО «Омега Коммуна» 123367 Российская Федерация,
 Москва, Троицкая улица, д. 16, корпус 1, 2 этаж, комната 4
 Тел: (495) 78-493 и 78-1466, E-mail: info@rff.ru
 Сайт: www.rff.ru www.rffportal.com
 © 2007. Все права защищены. RFF

Рыскон № 15



Qetropal

ПОЛИСУЛЬФОН: LPS - ПИКОЛ, № 3


С РАЗЛИЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ РАБОТЫ НА РАБОТНОМ МЕСТЕ

СЕРИЯ Г. РИ - БЫСОКАЯ


Модель:	LPS 250
Метод стерилизации:	Я
Lot:	S 07521
Год:	2021.08
Дата стерилизации:	2021.08
№ 1	2024.08

3 800072 417280


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с низкой пропускной способностью (LPS), модель: LPS 260

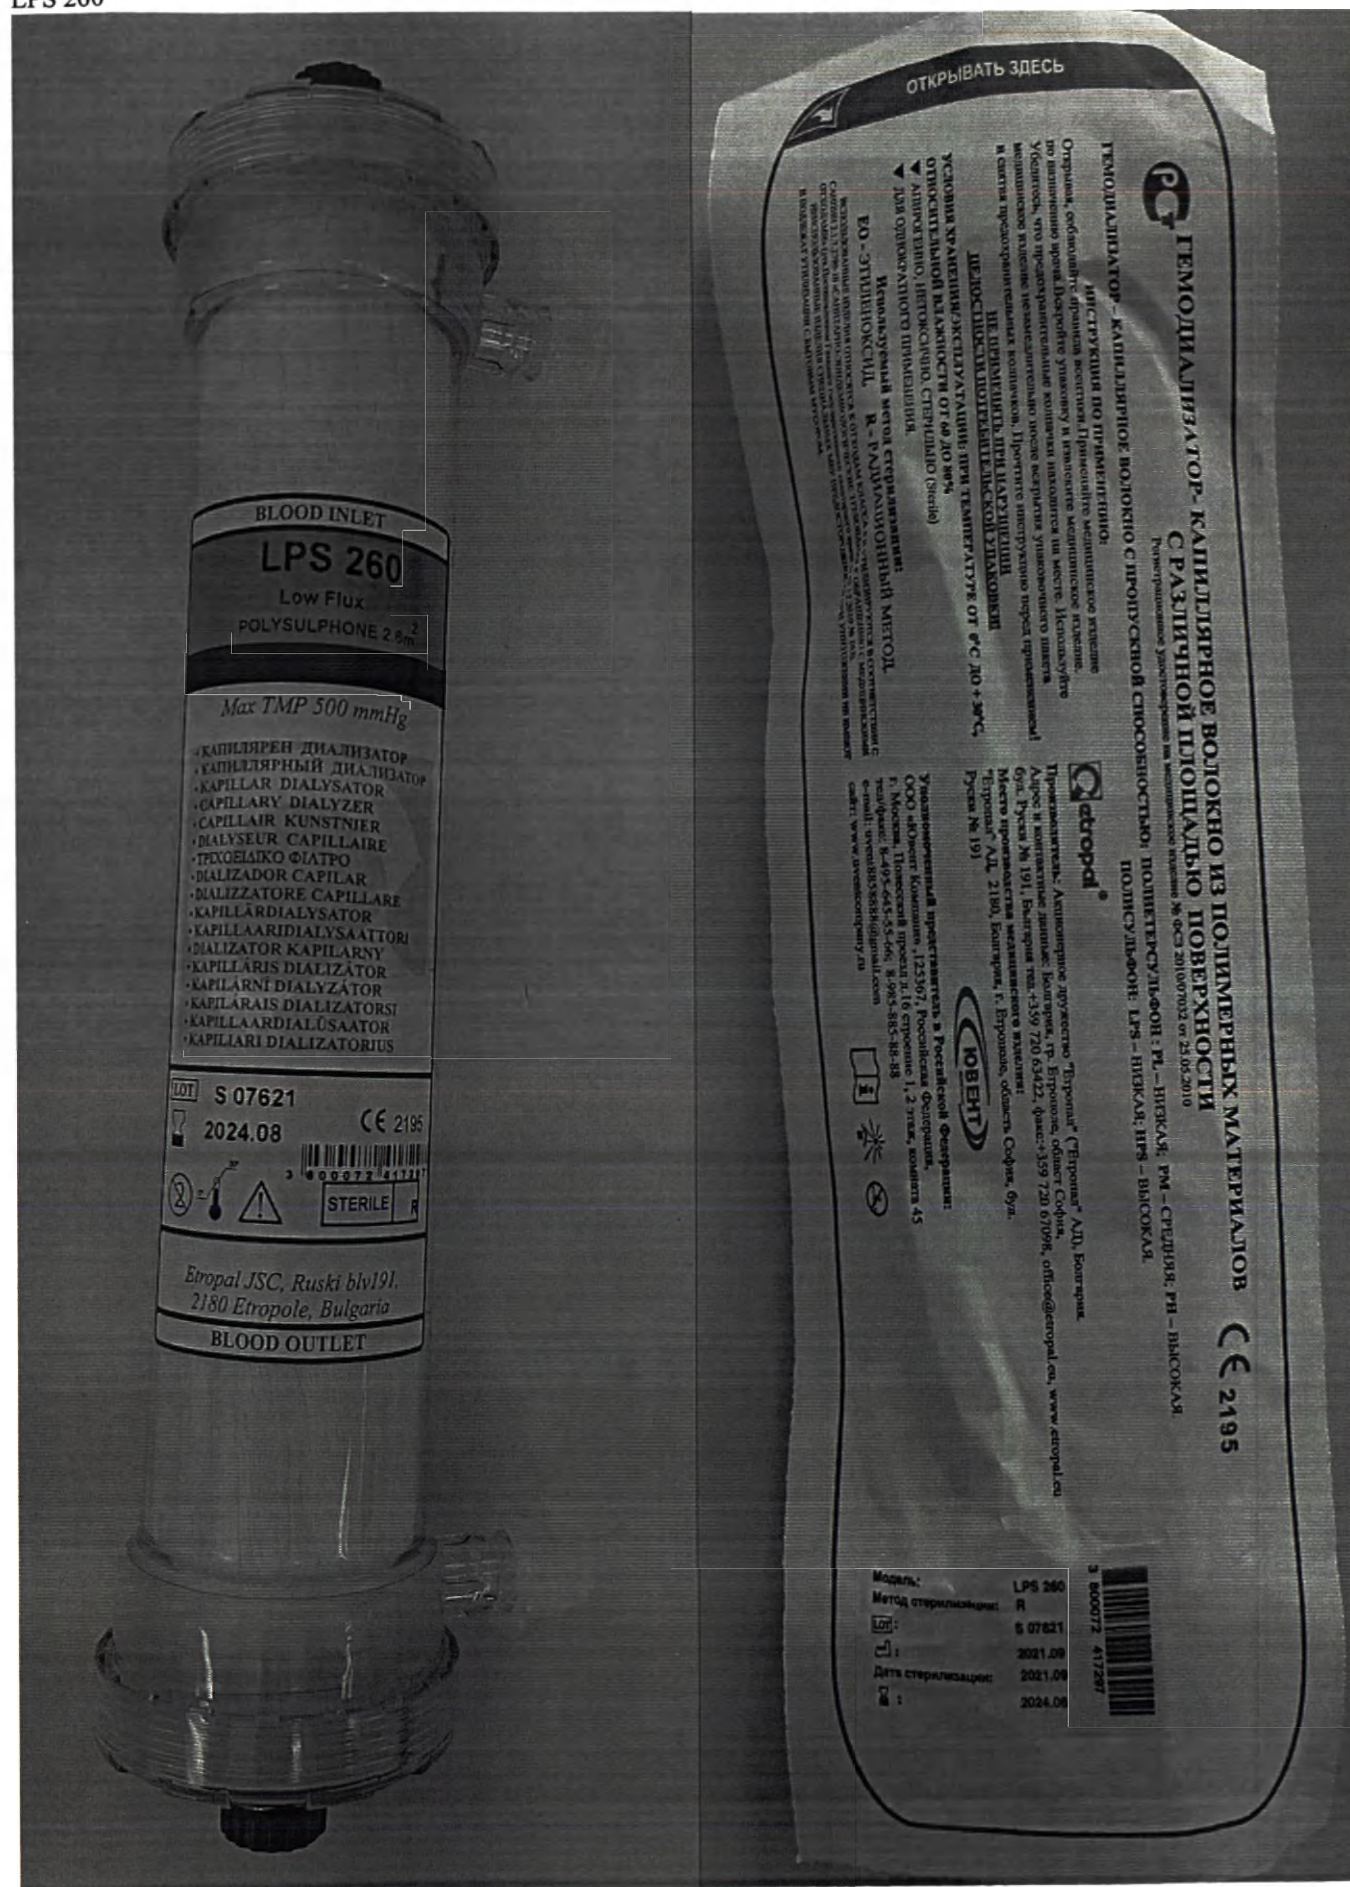


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с низкой пропускной способностью (LPS), модель: LPS 270

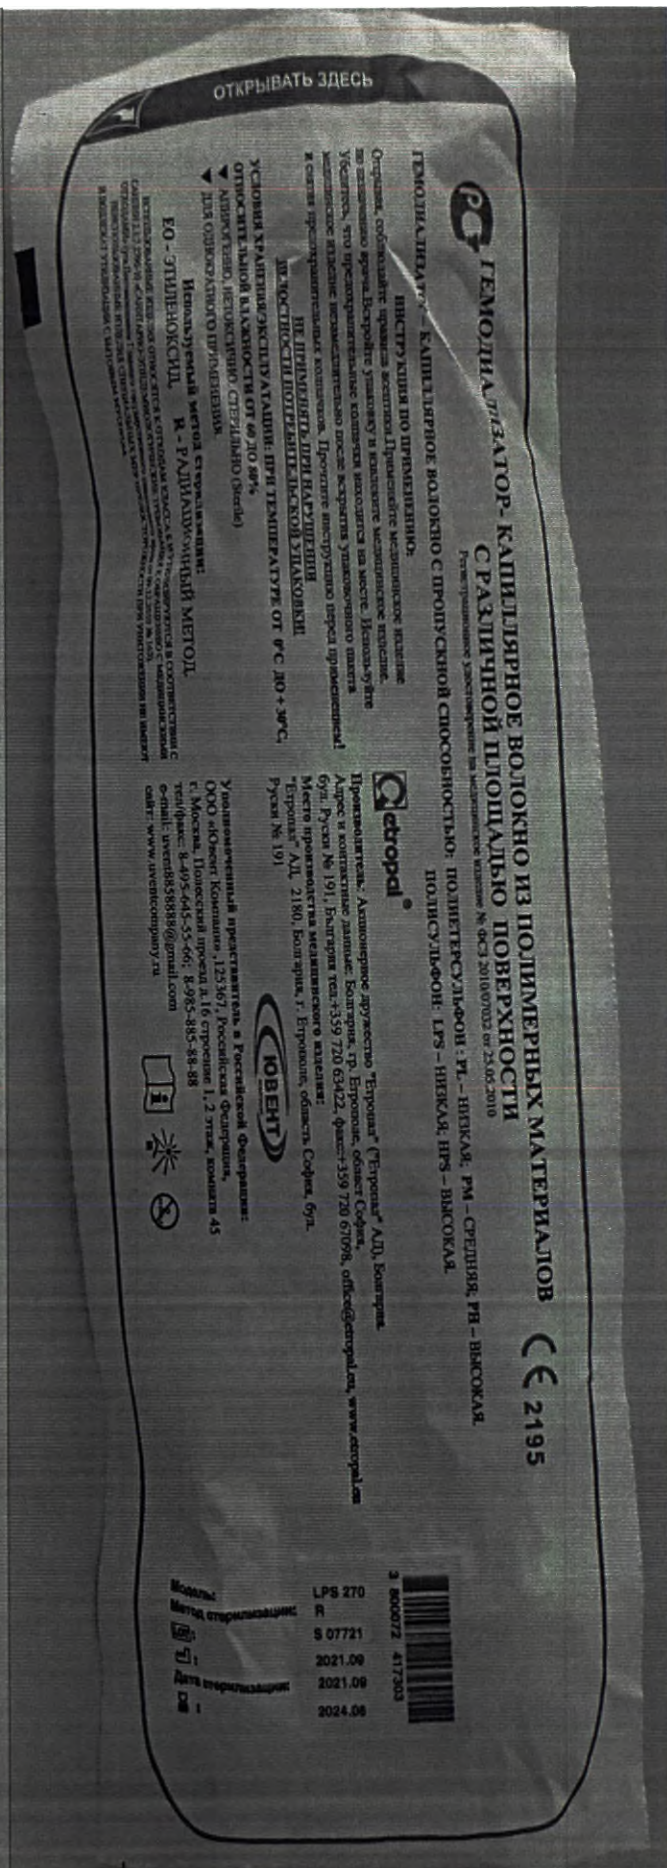

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с высокой пропускной способностью (HPS), модель: HPS 100

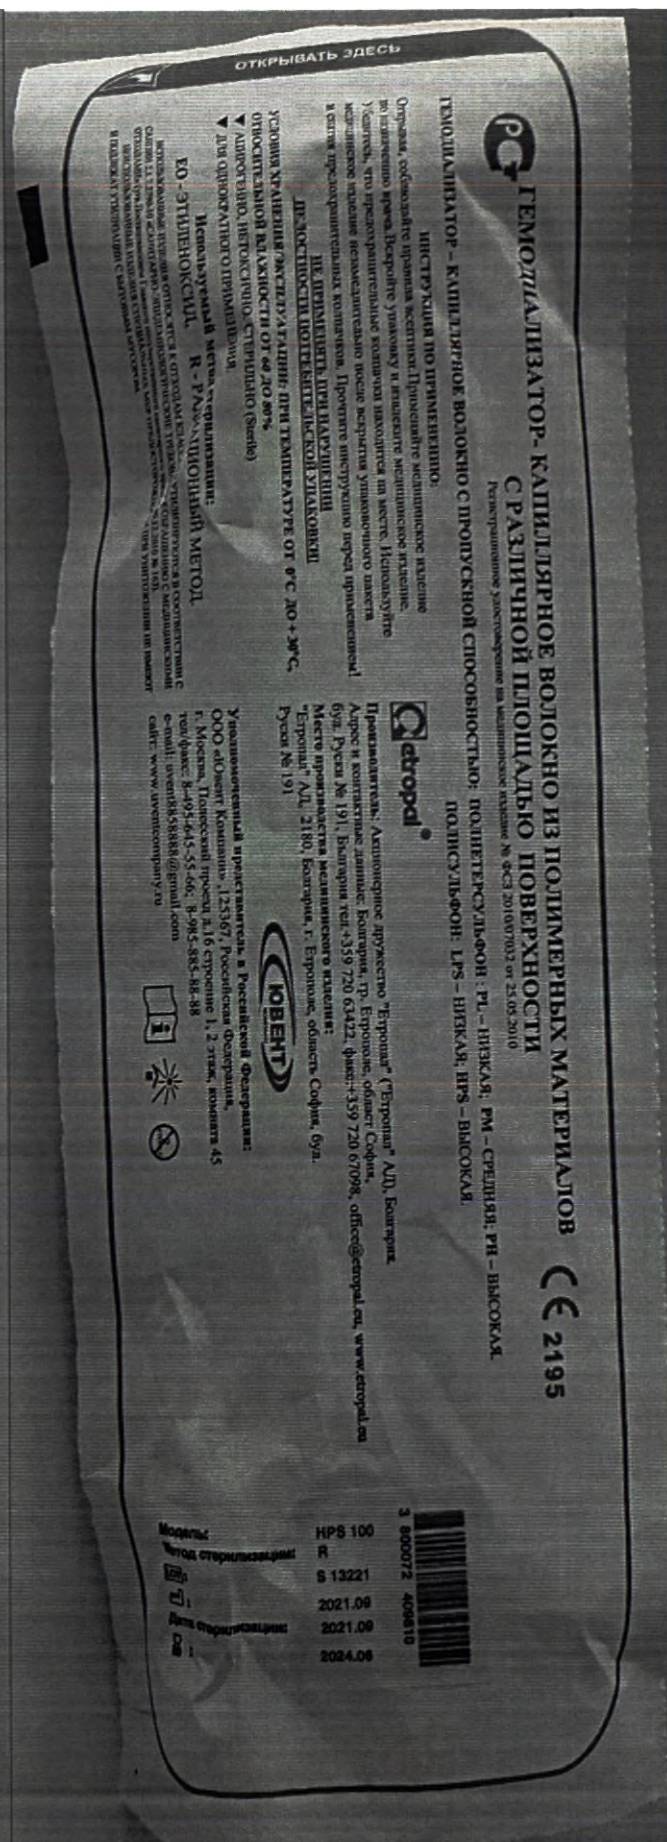


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с высокой пропускной способностью (HPS), модель: HPS 110

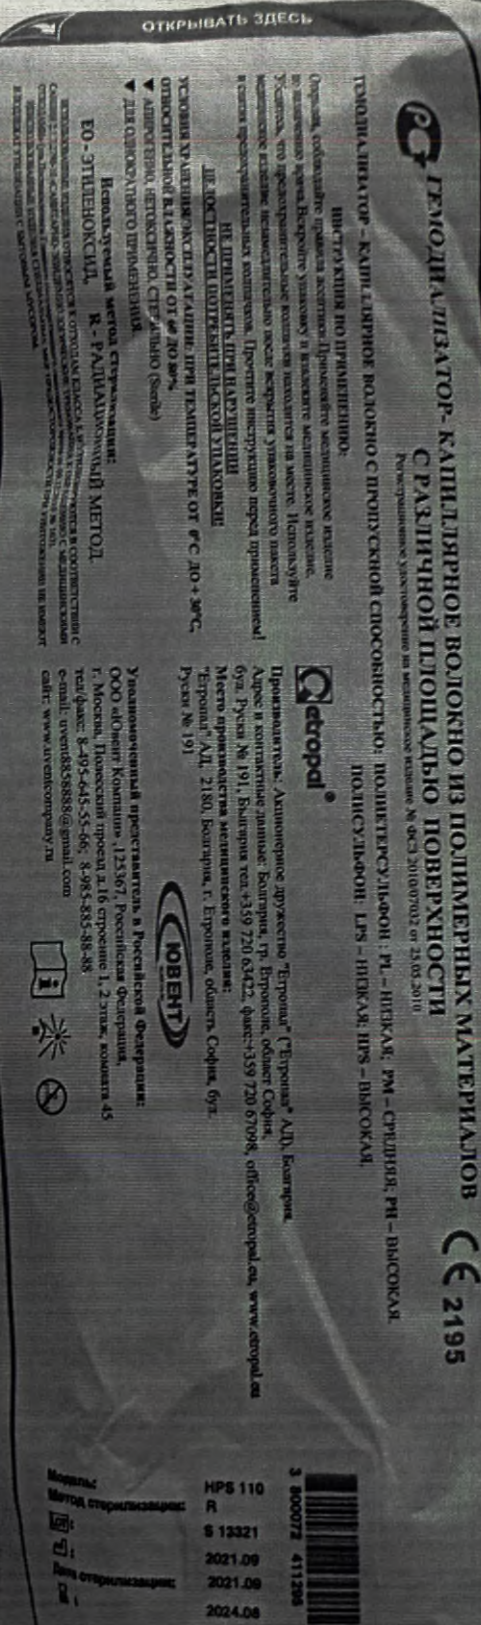

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с высокой пропускной способностью (HPS), модель: HPS 120

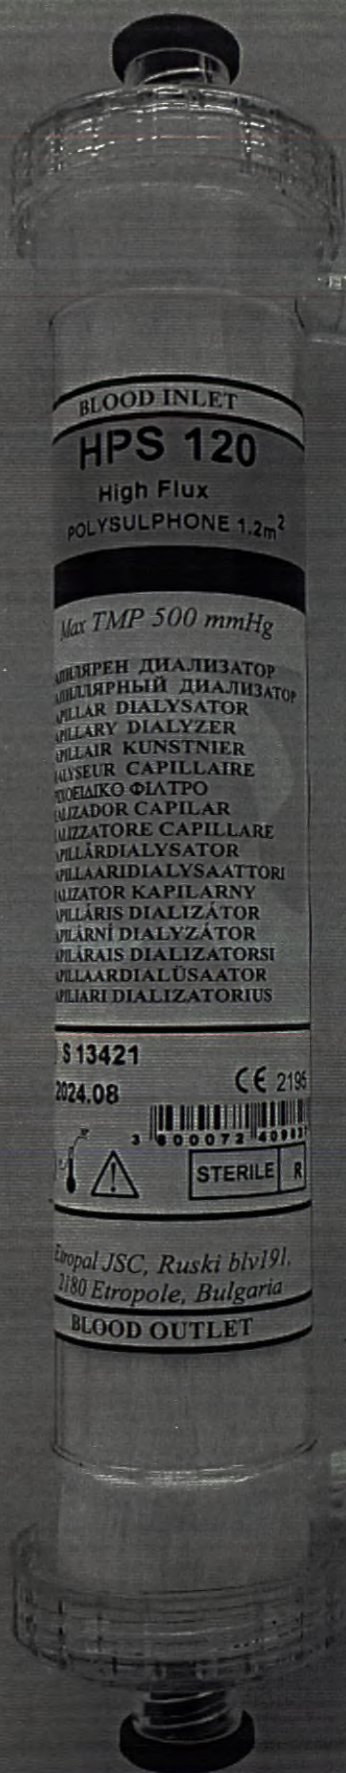

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ
 Регистрационный номер в Минздраве: № ФСЗ 20.10.07012 от 25.05.2010

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
 Определяющее свойство мембраны. Проницаемость мембраны к воде, что обеспечивает высокую пропускную способность. Уменьшение проницаемости мембраны к воде приводит к уменьшению пропускной способности мембраны. Проницаемость мембраны к воде определяется площадью поверхности мембраны. Проницаемость мембраны к воде определяется площадью поверхности мембраны. Проницаемость мембраны к воде определяется площадью поверхности мембраны.

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
 УСТАНОВИТЬ НА ПОВЕРХНОСТИ ПАЦИЕНТА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +16 ДО +38°C.
 ОПРЕДЕЛЕННАЯ ВЛАЖНОСТЬ ОТ 60 ДО 90%.
 НЕ ПОДДАЕТСЯ ПОВРЕЖДЕНИЮ СТЕРИЛЬНОСТЬЮ (Sartol).

ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ
 ЕО - ЭТАПОВЫЙ МЕТОД. В ЧИСТЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД.

Удостоверенный представитель в Российской Федерации:
 ООО «Европал», 125367, Российская Федерация, г. Москва, Поневский проезд д.16 строение 1, 2 этаж, комната 45
 телефон: 8-495-645-55-66, 8-495-885-88-88
 e-mail: info@etropal.ru, etropal@etropal.ru
 сайт: www.etropal.ru

Продукция: Акционерное общество "Европал" (Европал) АД, Болгария.
 Адрес и контактные данные: Болгария, гр. Етрополе, область София, бул. Руски №191, 2180. Контактный тел. +359 720 63422, факс: +359 720 67098, office@etropal.eu, www.etropal.eu
 Место производства мембранного изделия: "Европал" АД, 2180, Болгария, г. Етрополе, область София, бул. Руски №191

ЮБЕНТ

СЕРТИФИКАТ


Модель: HPS 120
 Метод стерилизации: R
 Lot: S 13421
 Дата: 2021.09
 Дата стерилизации: 2021.09
 №: 1 2024.08

3 800072 40827

CE 2195


Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с высокой пропускной способностью (HPS), модель: HPS 130

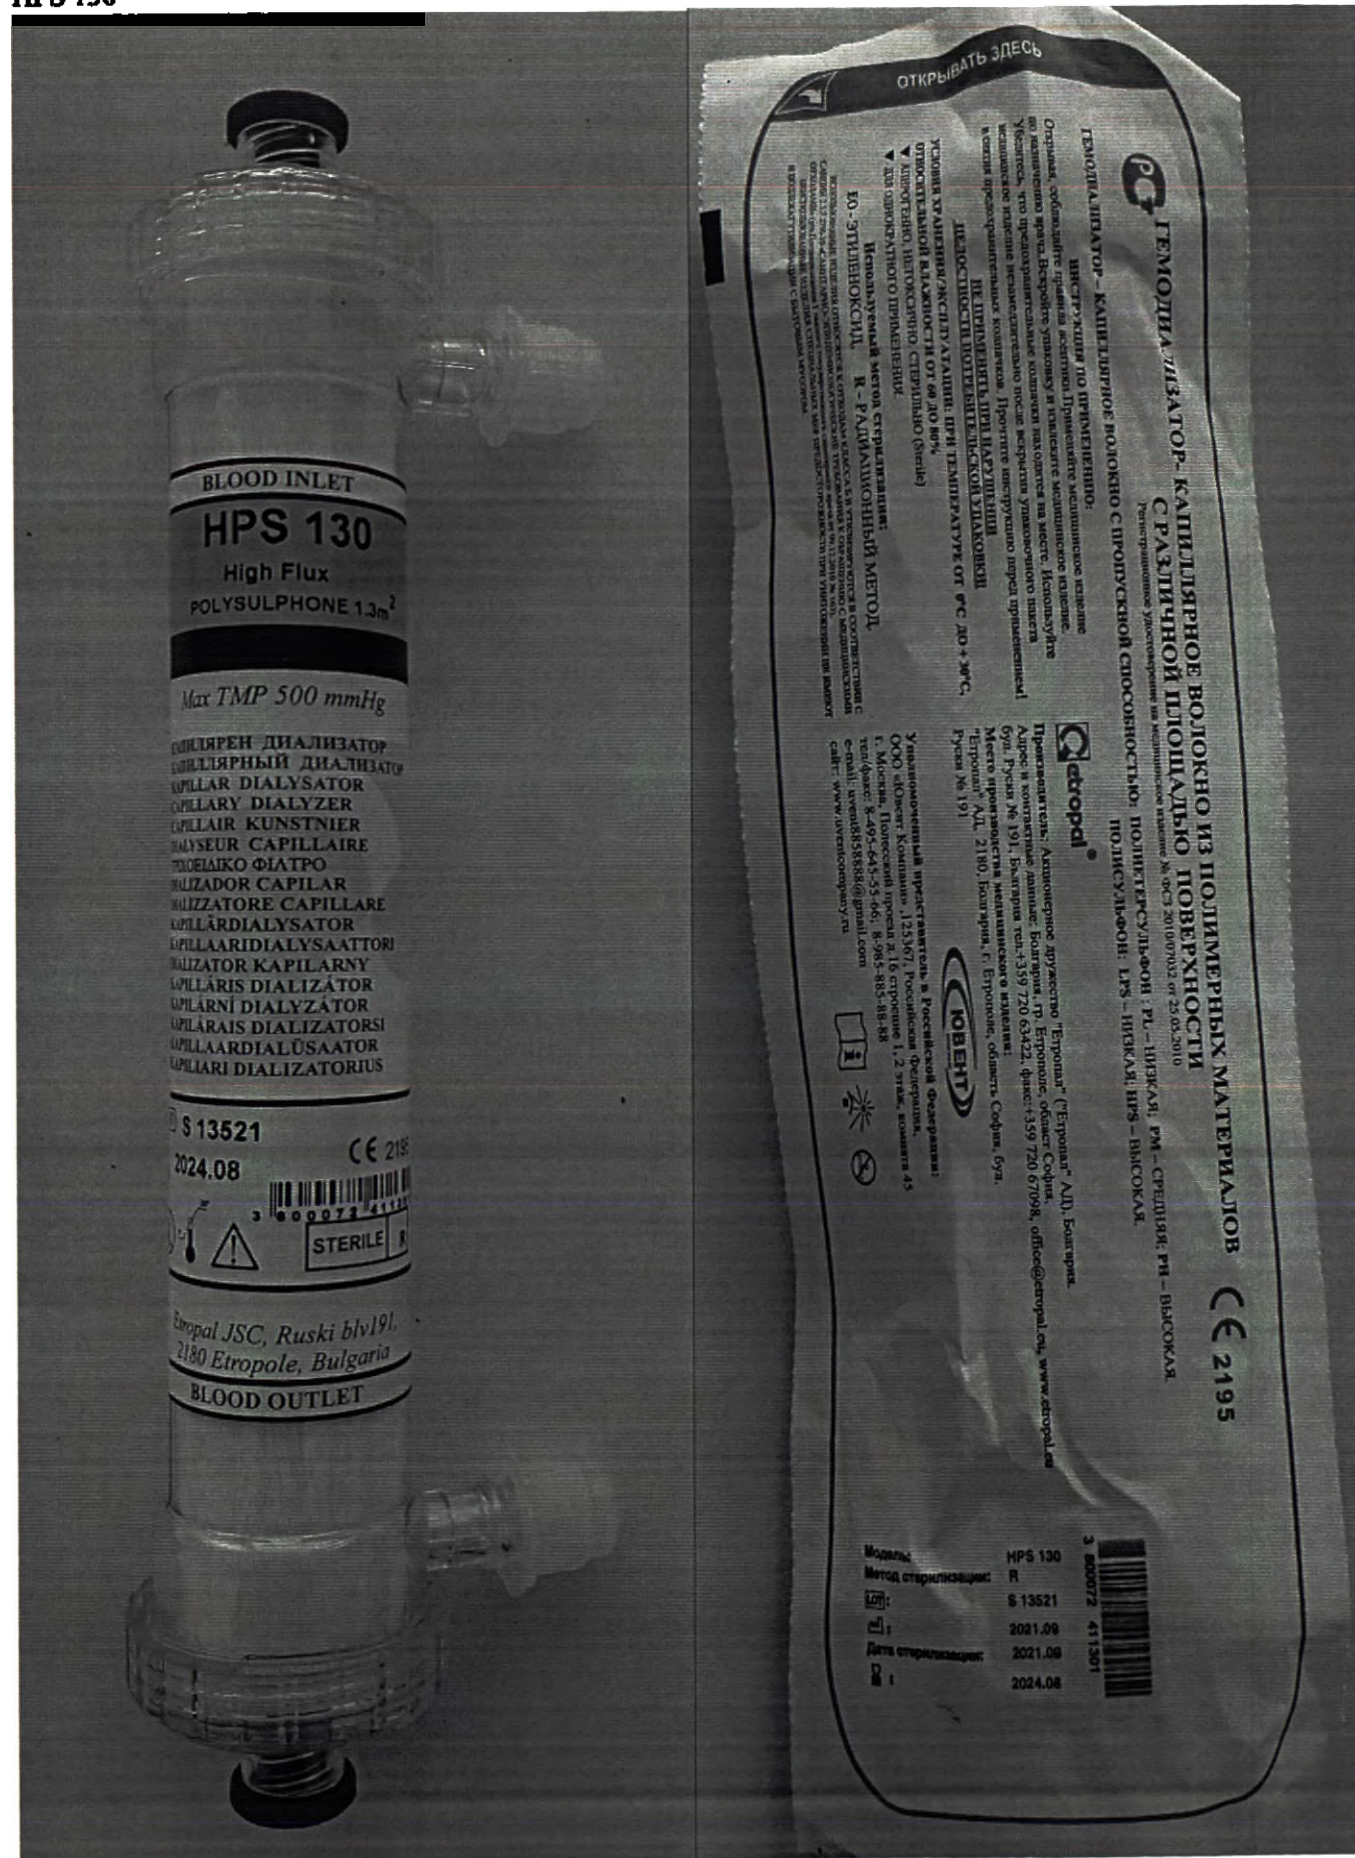

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с высокой пропускной способностью (HPS), модель: HPS 140

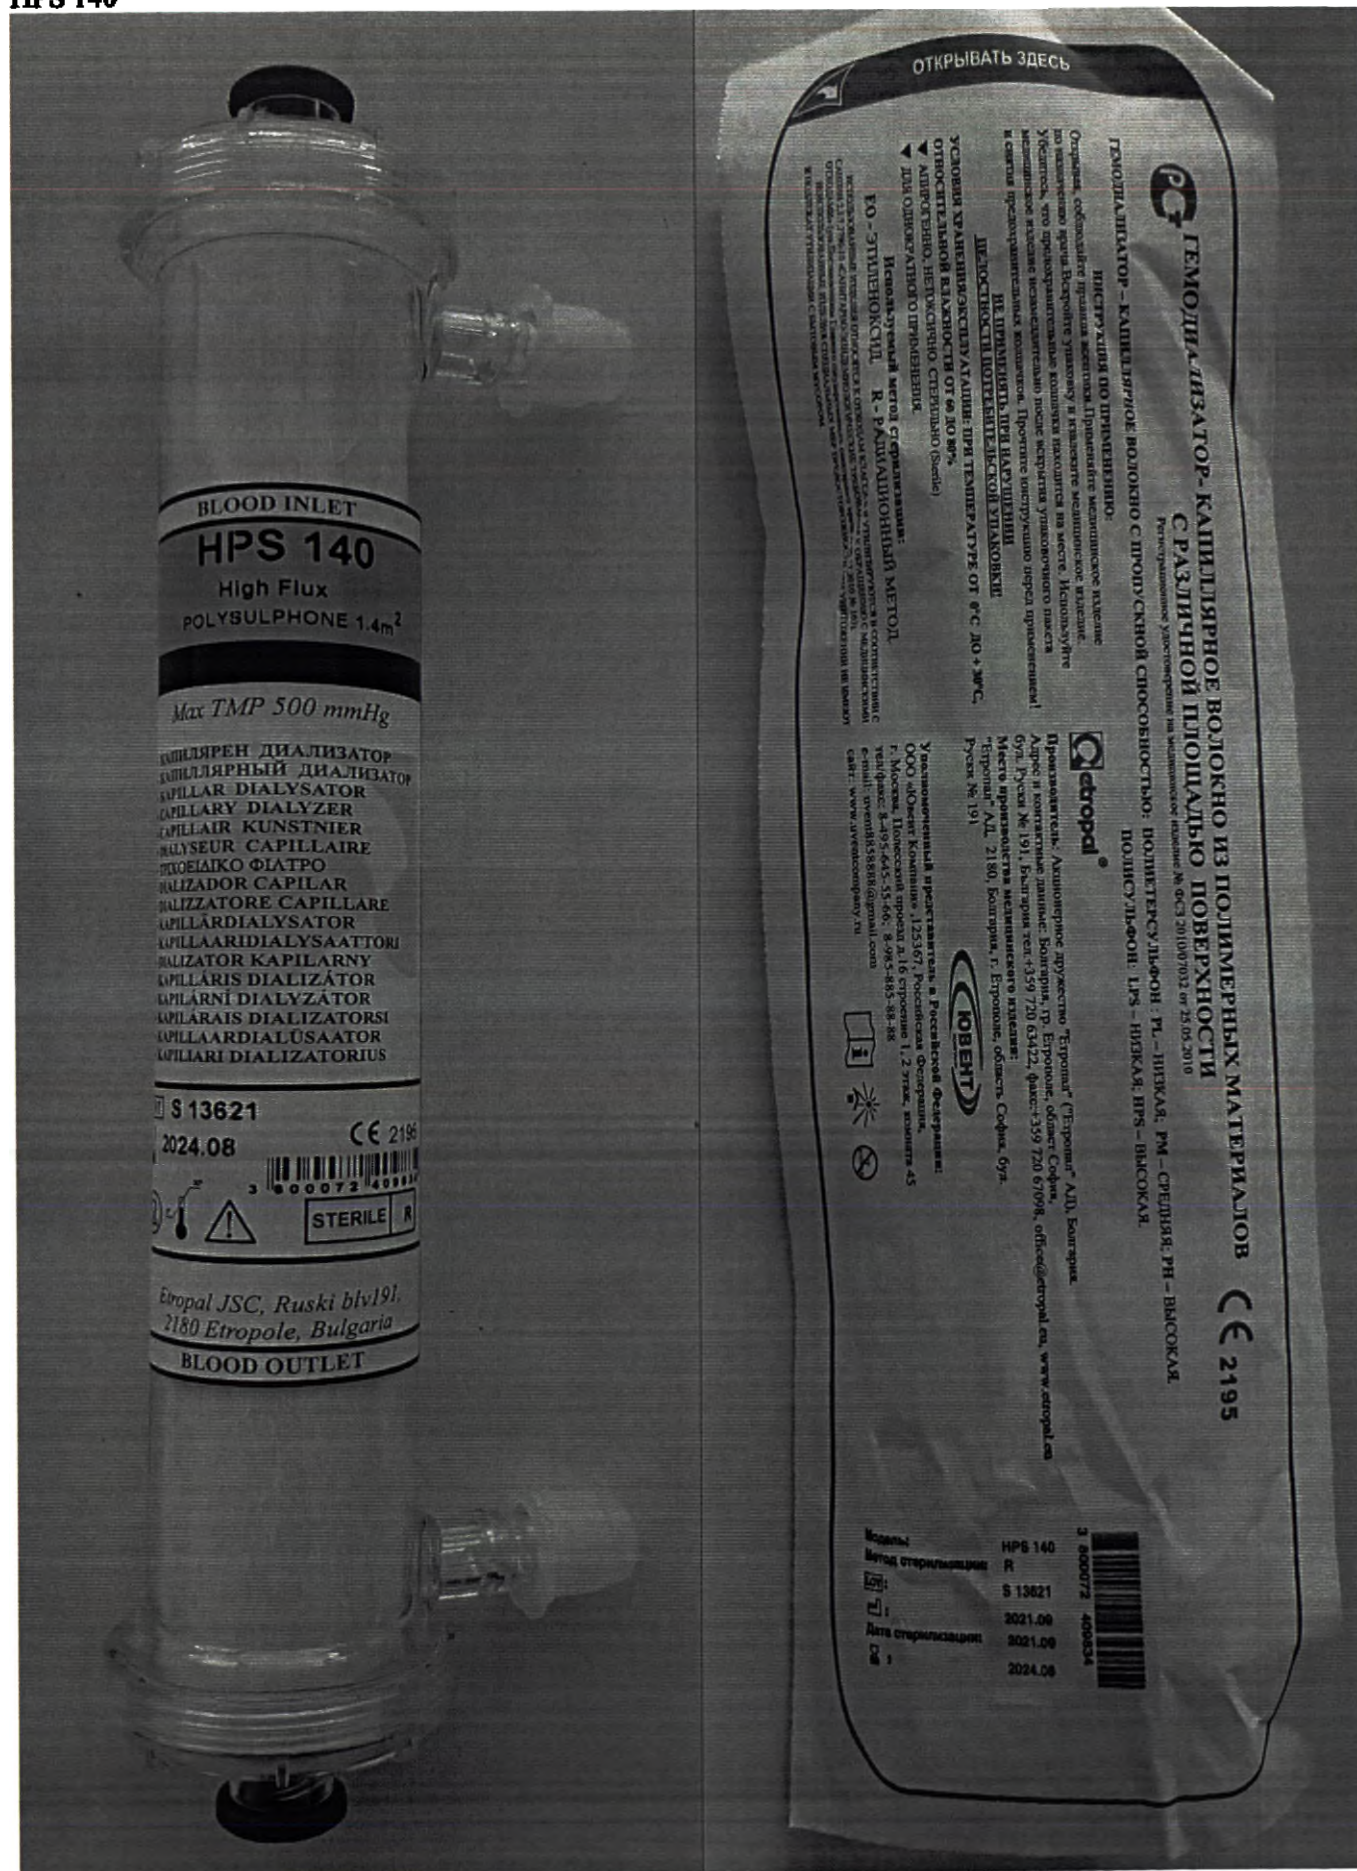

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ
 Регистративное удостоверение на медицинское изделие № ФСЗ 2010/07/03 от 25.05.2010
 Полисульфонов: LPS - НИЗКАЯ, PM - СРЕДНЯЯ, PH - ВЫСОКАЯ.

ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЛЯРНОЕ ВОЛОКНО С ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ: ПОЛИСУЛЬФОН




Представитель: Медицинское общество "Европол" ("Etropal" AD), Болгария.
 Адрес и контактные данные: Болгария, гр. Етрополе, область София, бул. Руски № 191, б/ч. д. 191, тел. +359 720 62422, факс: +359 720 61099, office@etropal.eu, www.etropal.eu

Место производства медицинского изделия:
 "Европол" АД, 2180, Болгария, г. Етрополе, область София, бул. Руски № 191



Уполномоченный представитель в Российской Федерации:
 ООО «Ювент Корпореишн», 125367, Российская Федерация, г. Москва, ул. Давыдовский проезд д.16 стропане 1, 2 этаж, кванта 45
 тел. +7 (495) 445-55-66, 8-985-885-88-88
 e-mail: info@juvent.ru, sales@juvent.ru, www.juvent.ru




Модель:	HPS 140
Материал:	R
Идентификационный код:	S 13621
Дата стерилизации:	2021.08
Дата:	2021.08
Срок годности:	2024.08




Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с высокой пропускной способностью (HPS), модель: HPS 150

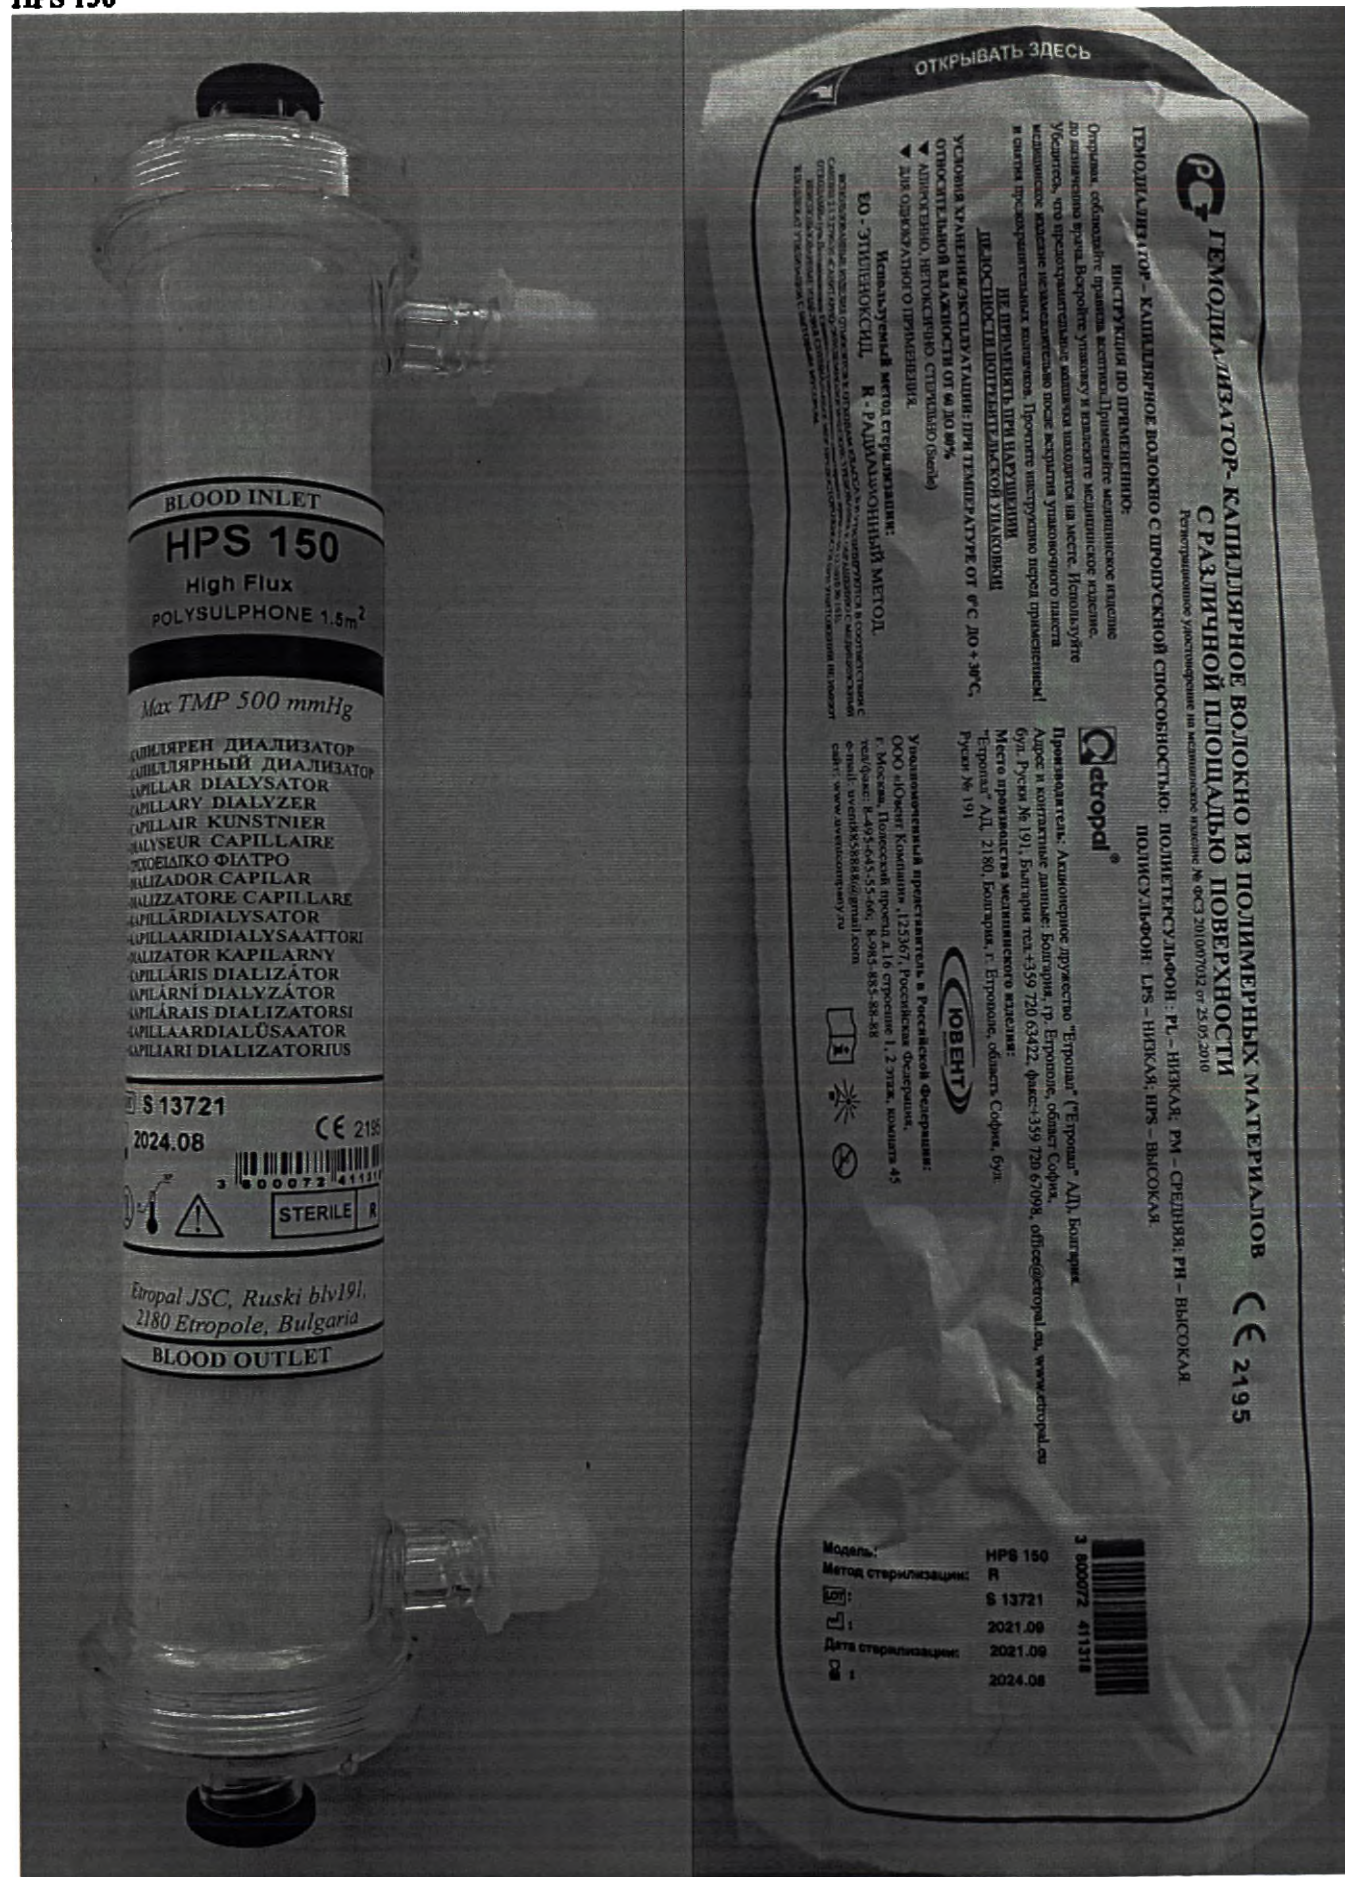

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с высокой пропускной способностью (HPS), модель: HPS 160

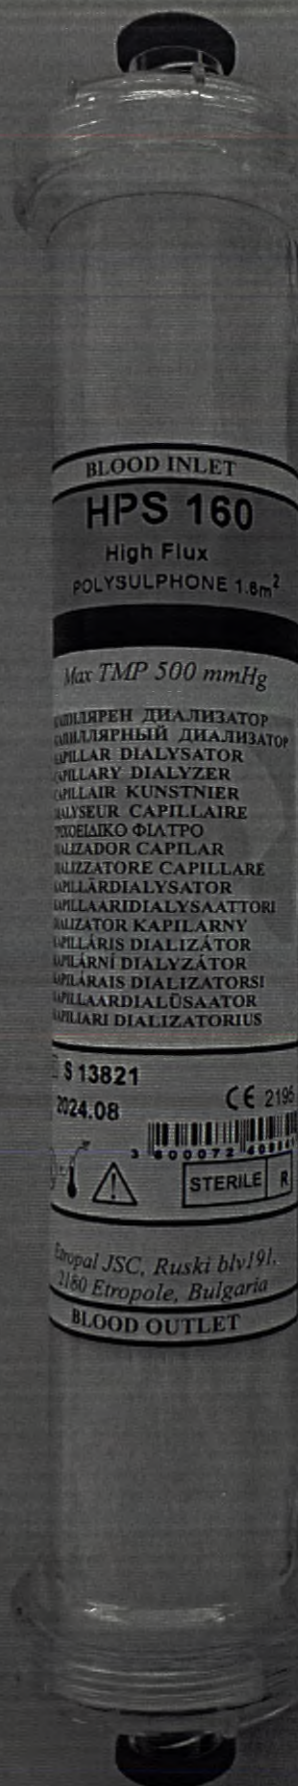

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

PC ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

Контрольное удостоверение на машинное изделие № 05-С 20100702 от 25.05.2010

ПОЛИСУЛФОН: LPS - НИЗКОЕ, HPS - ВЫСОКОЕ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Оформляя, соблюдайте правила техники безопасности. Примените необходимые меры предосторожности. Вскрытие упаковки и извлечение машинного изделия. Убедитесь, что предохранительная пломба находится на месте. Непосредственно перед использованием тщательно вымойте руки. Проверьте инструкцию перед применением! И если предохранительная пломба отсутствует, не применяйте прибор!

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ:

1. ДАВНОСТИ ПОТОКА КРОВИ ИЛИ ДАВНОСТИ ВОЛОКНА

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ: ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 0°C ДО +30°C

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ОТ 60 ДО 80%

▲ АБСОЛЮТНО НЕКОСНУТЬСЯ, СТЕЖИТЬ (Seal)

▲ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Используемый метод стерилизации:

ВО - ЭТЕНОКСИД, R - РАДИКАЦИОННЫЙ МЕТОД.

Продукт не подлежит повторному использованию. При нарушении целостности упаковки, продукт не подлежит использованию. При нарушении целостности упаковки, продукт не подлежит использованию. При нарушении целостности упаковки, продукт не подлежит использованию.

Etropal

Продукты: Аппаратное устройство "Etropal" АД, Болгария.

Адрес и контактные данные: Болгария, гр. Етрополе, община София, 696, Руски бл. 191, България тел: +359 720 63422, факс: +359 720 67098, office@etropal.bg, www.etropal.bg

Место производства машинного изделия в клинике: "Etropal" АД, 2180, Болгария, гр. Етрополе, община София, 696, Руски бл. 191


Уполномоченный представитель в Российской Федерации: ООО «Ювент Компани», 125367, Российская Федерация, г. Москва, Подольский проезд д.16 строение 1, 2 этаж, комната 45 тел/факс: 8-495-645-55-66, 8-495-885-88-88 email: info@juvent.com, sales@juvent.com

ЮВЕНТ


Модель: HPS 160
Метод стерилизации: R
S 13821
2021.09
Дата стерилизации: 2021.09
2024.08

3 600072 409841

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с высокой пропускной способностью (HPS), модель: HPS 170

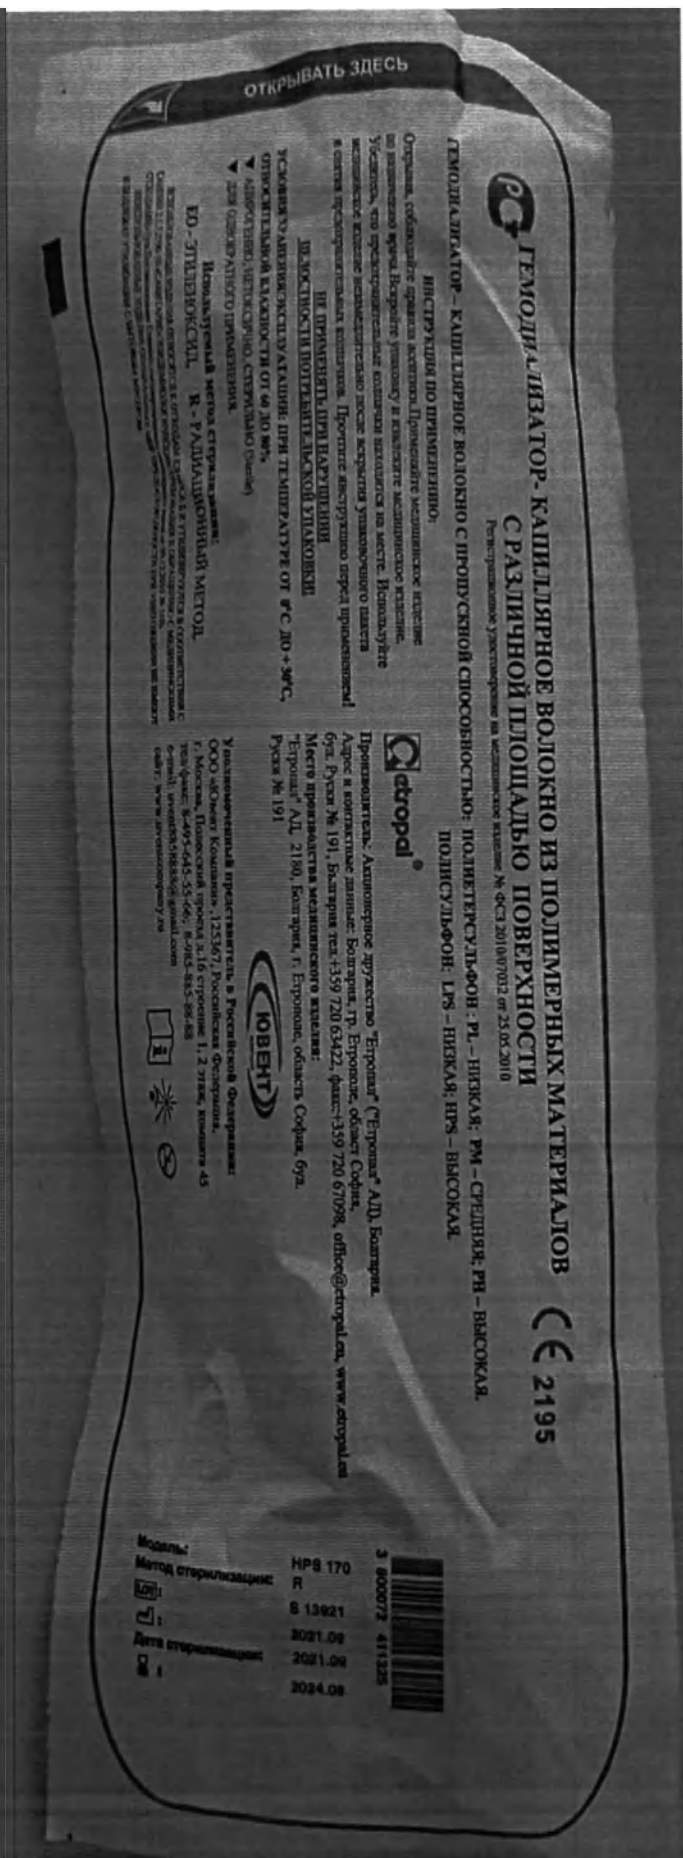


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полнисулфон с высокой пропускной способностью (HPS), модель: HPS 180

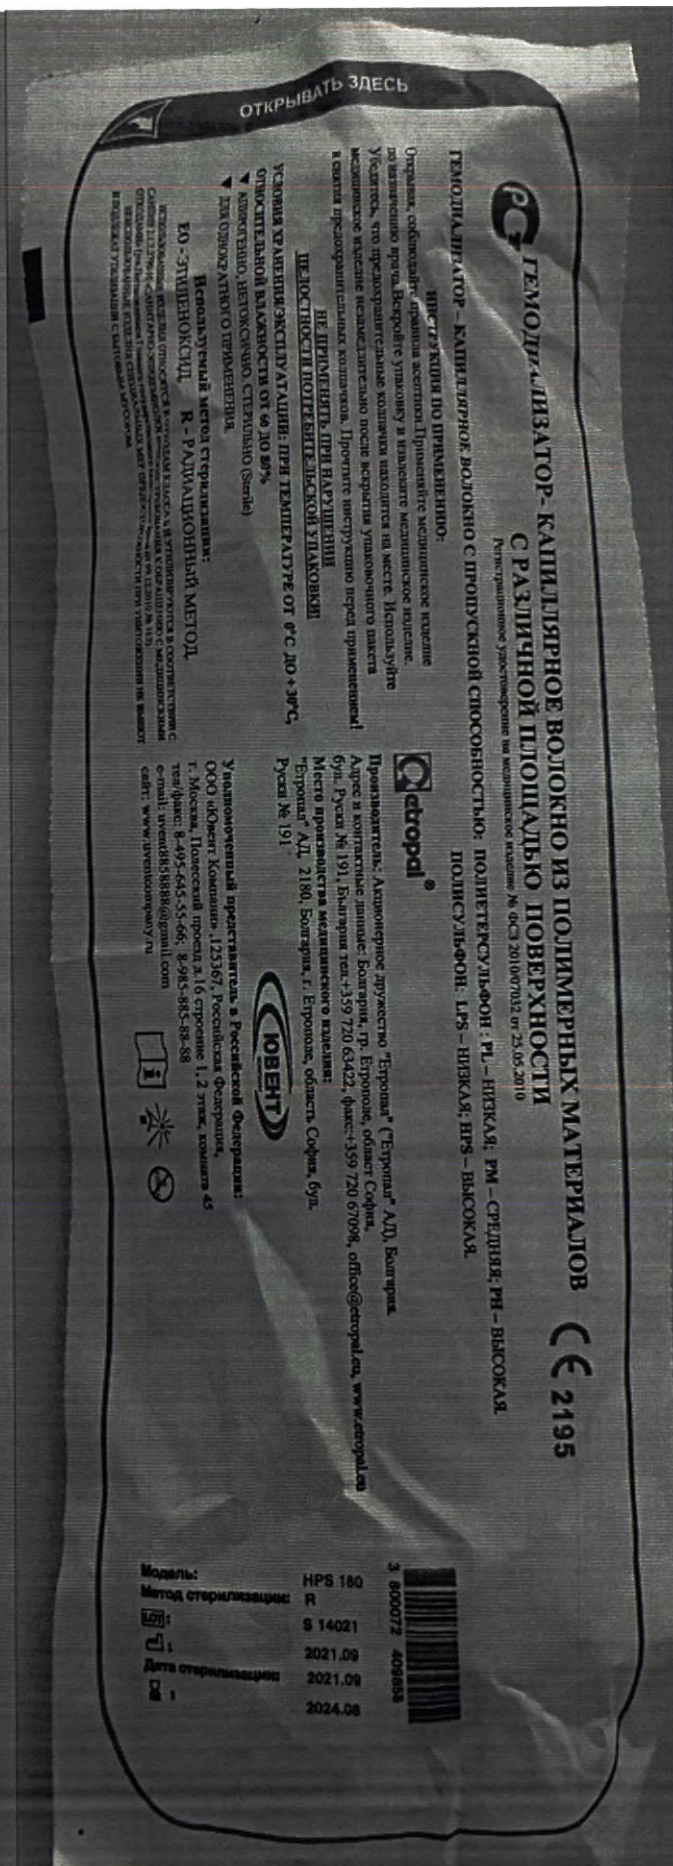


Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с высокой пропускной способностью (HPS), модель: HPS 190

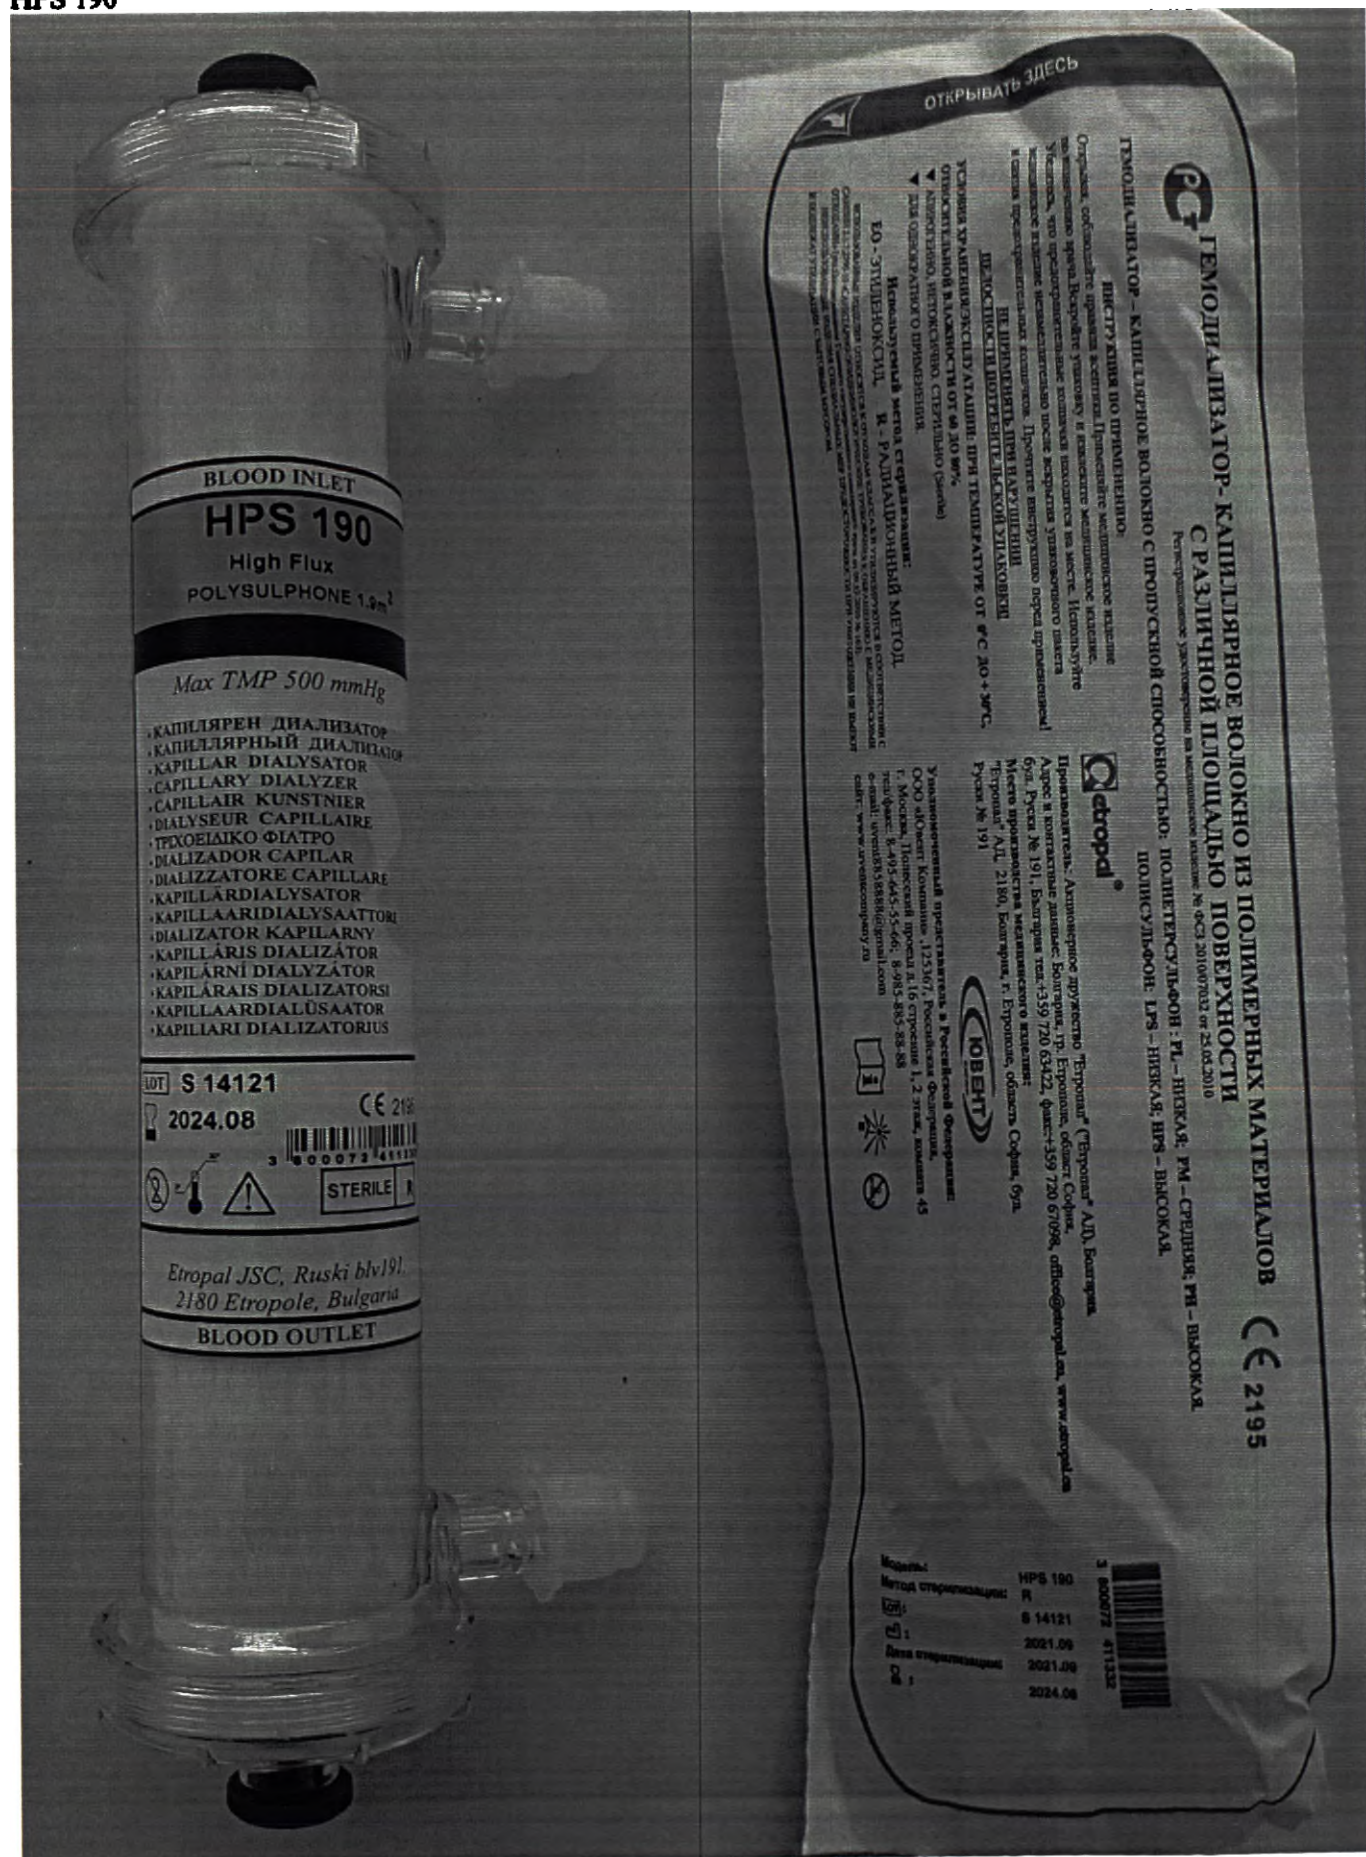


Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с высокой пропускной способностью (HPS), модель: HPS 200

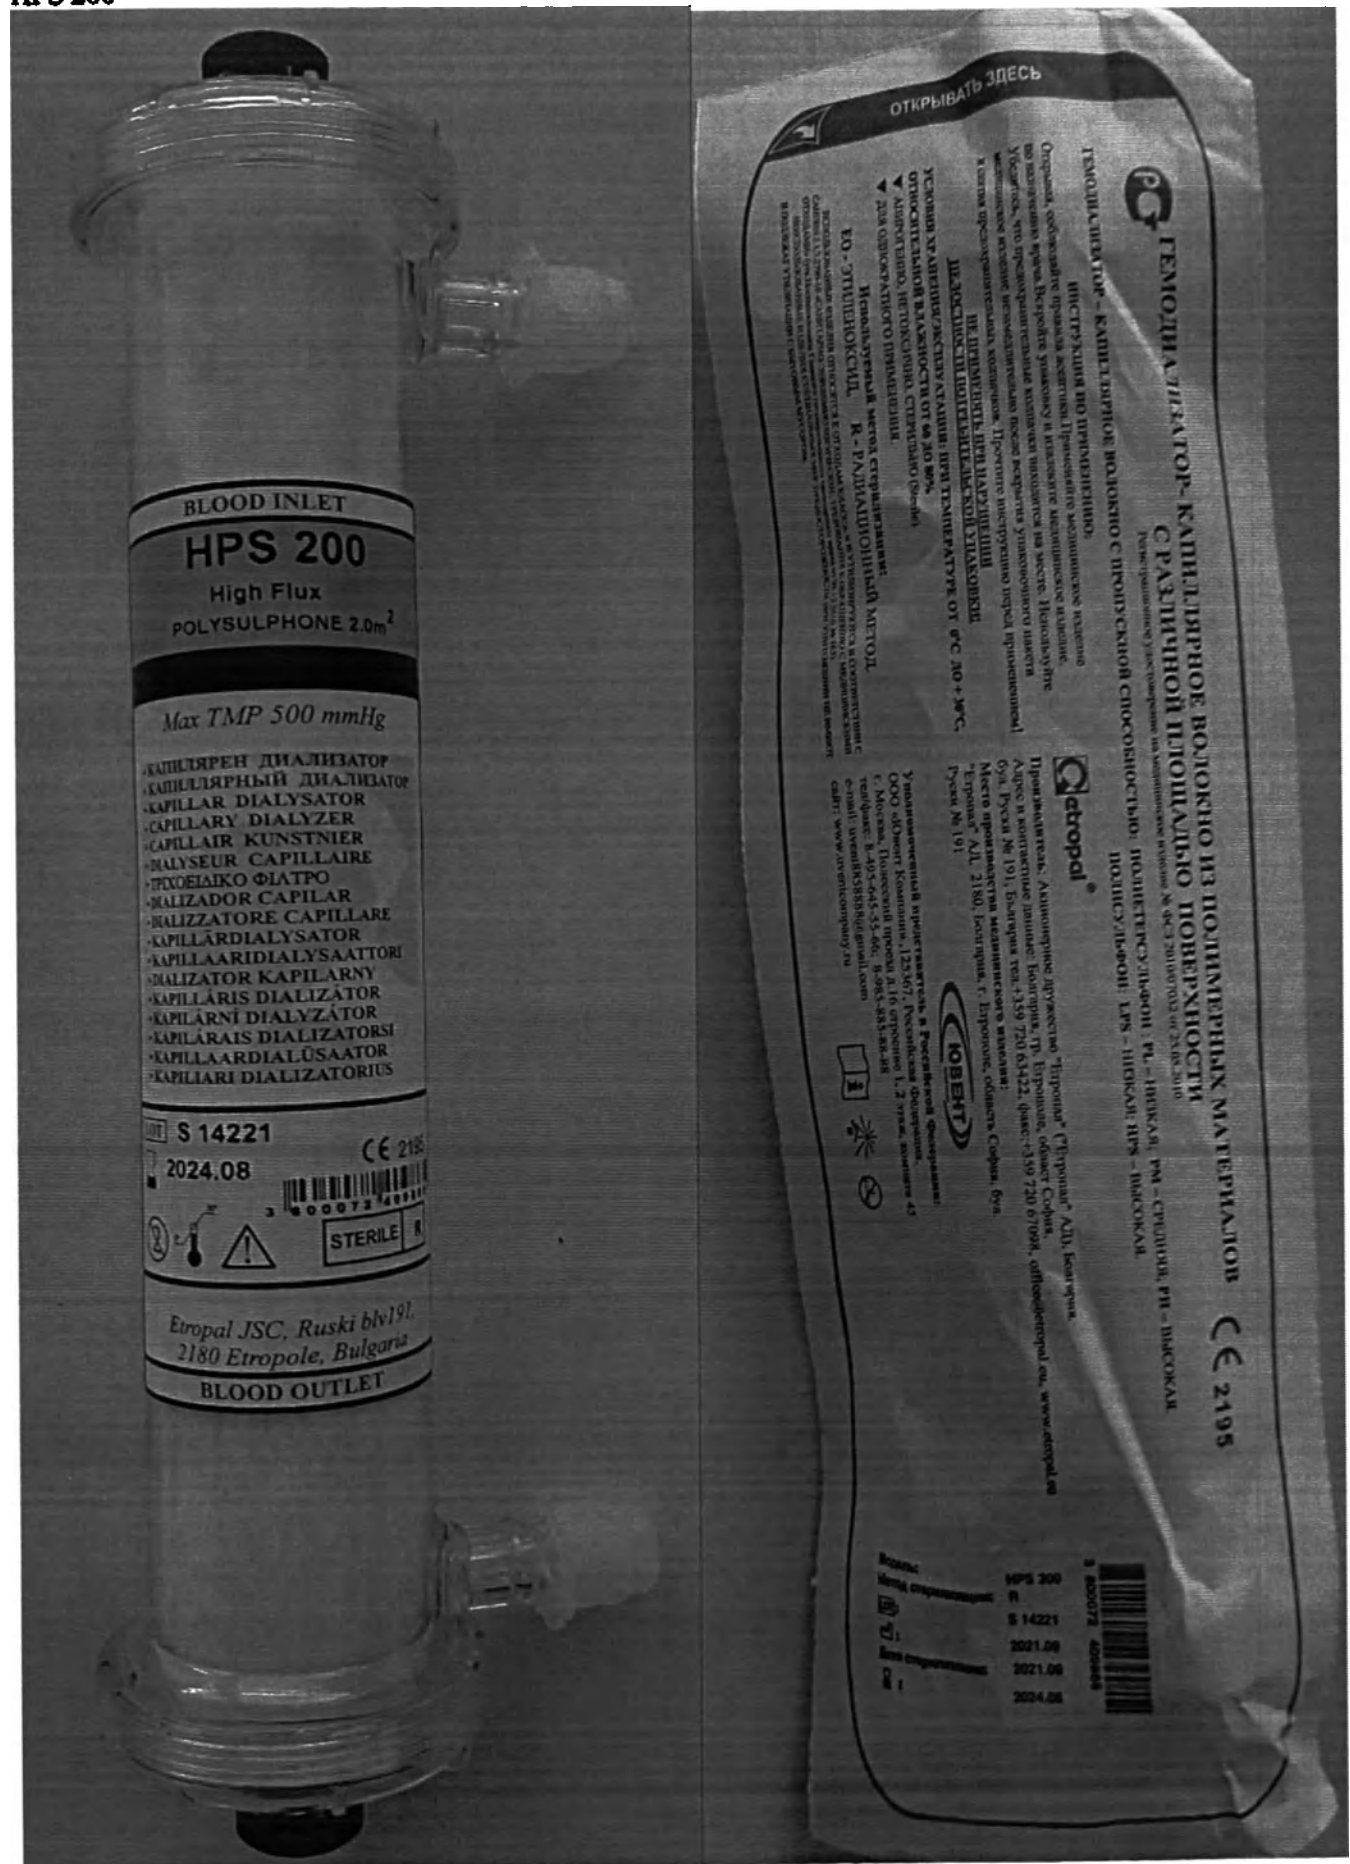

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с высокой пропускной способностью (HPS), модель: HPS 210

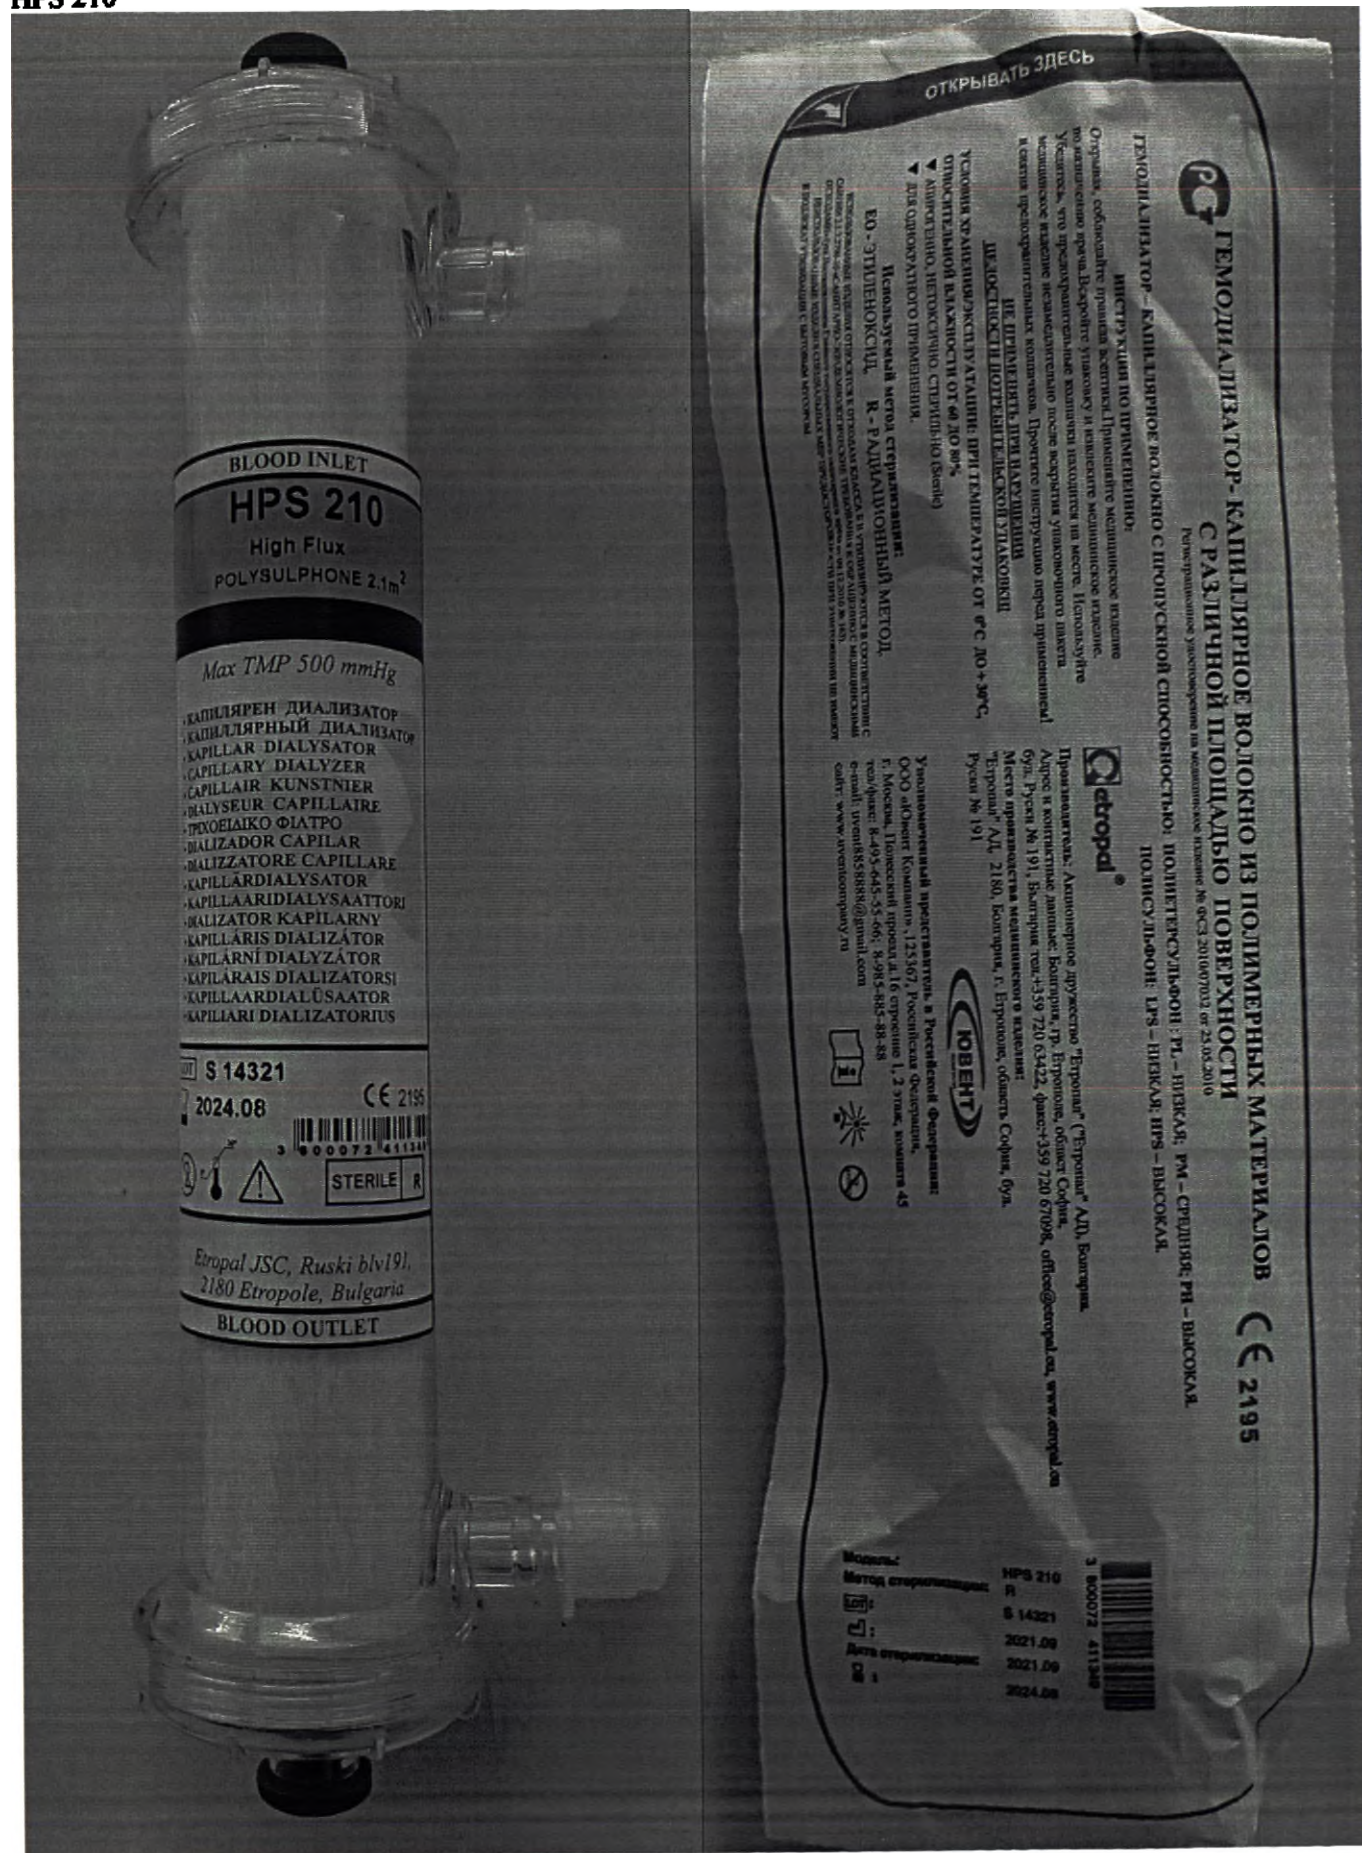


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с высокой пропускной способностью (HPS), модель: HPS 220



Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с высокой пропускной способностью (HPS), модель: HPS 230

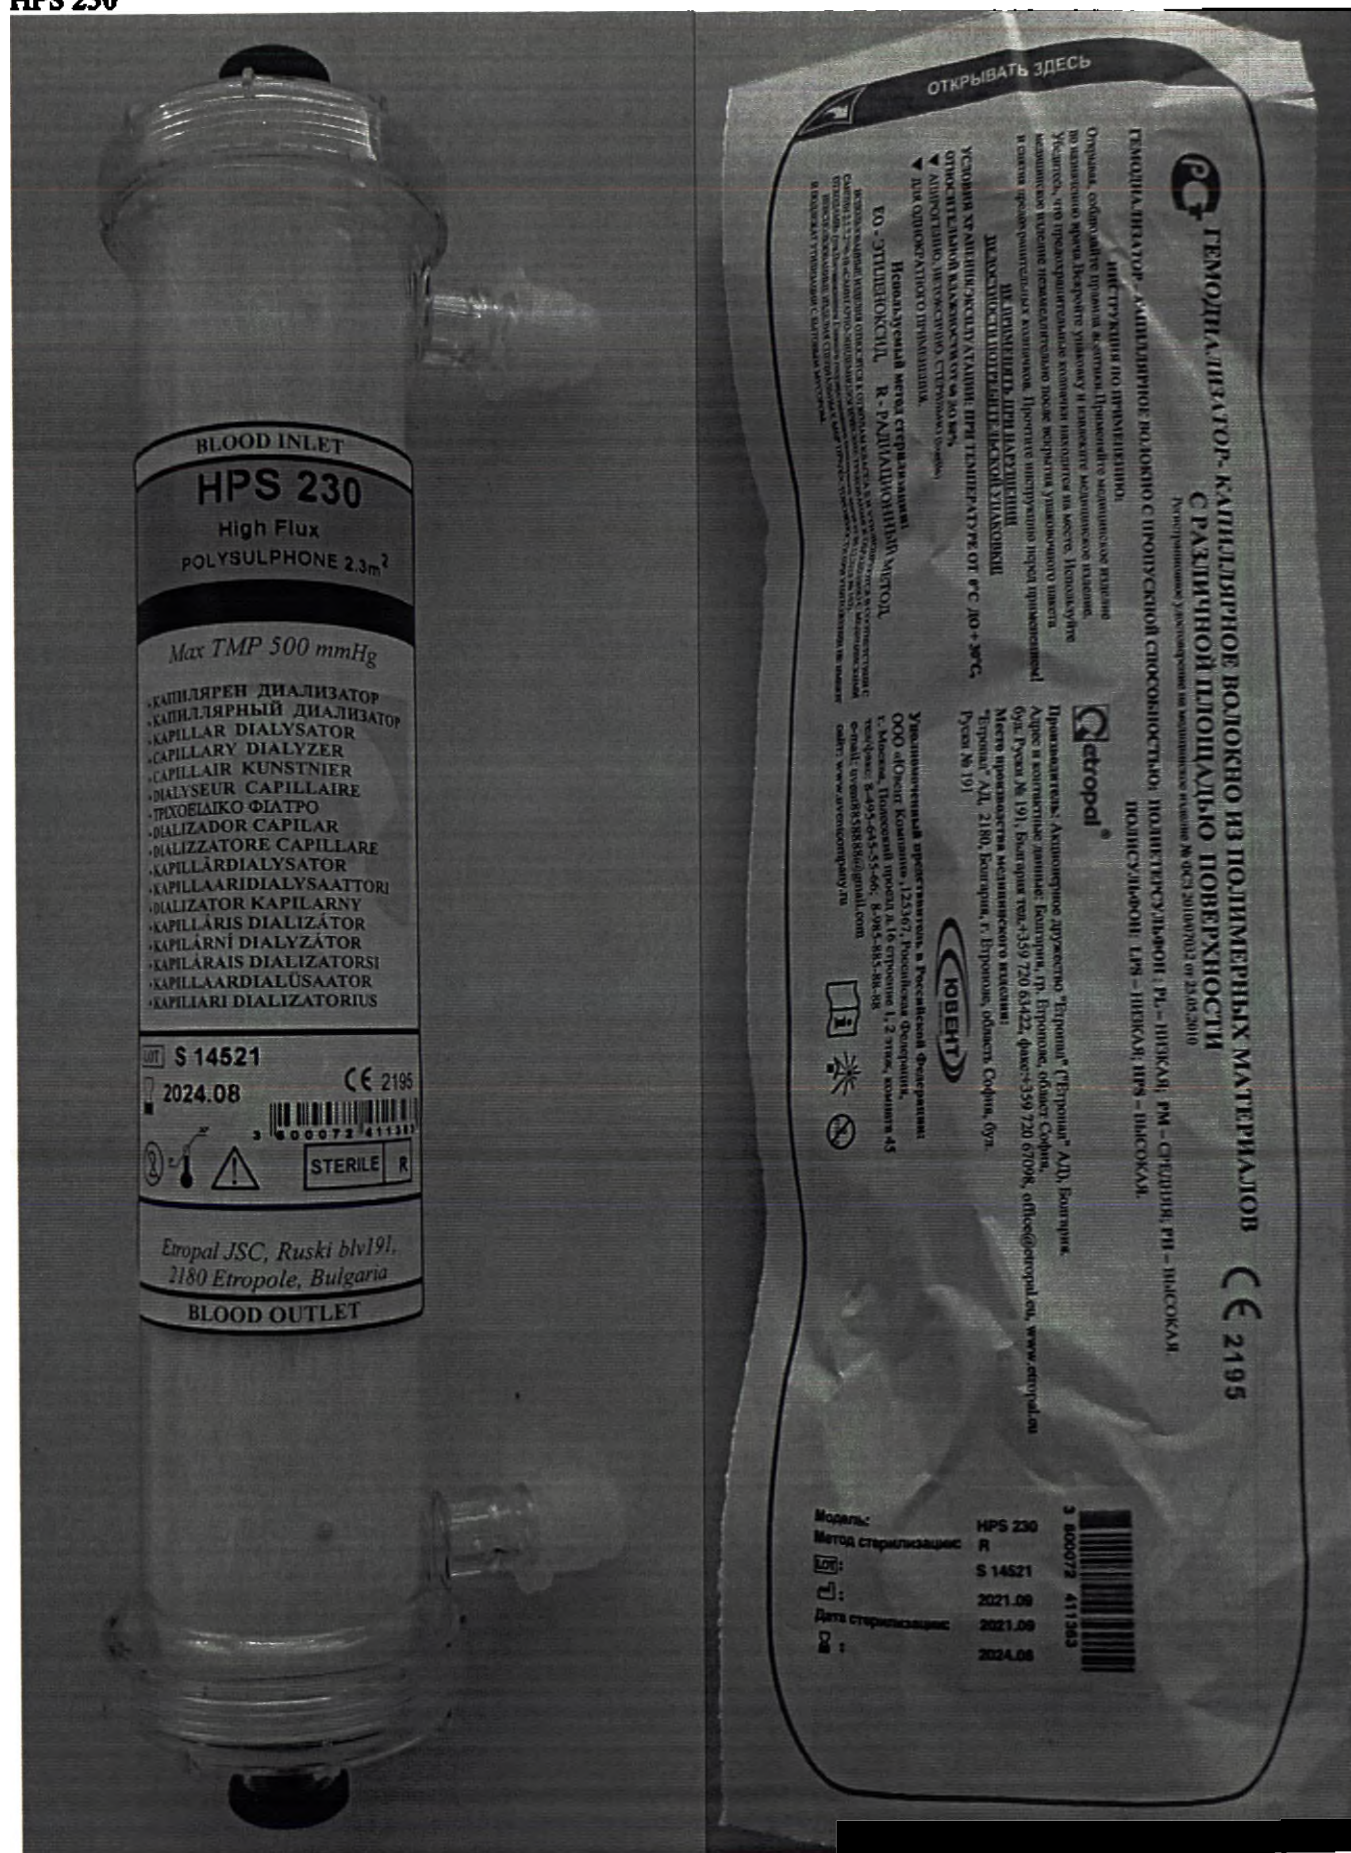

BLOOD INLET
HPS 230
 High Flux
 POLYSULPHONE 2.3m²
 Max TMP 500 mmHg
 • КАПИЛЯРЕН ДИАЛИЗАТОР
 • КАПИЛЯРНЫЙ ДИАЛИЗАТОР
 • CAPILLAR DIALYSATOR
 • CAPILLARY DIALYZER
 • CAPILLAIR KUNSTNIER
 • DIALYSEUR CAPILLAIRE
 • ТРОХОЕЛАΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ
 • DIALIZADOR CAPILAR
 • DIALIZZATORE CAPILLARE
 • KAPILLÄRDIALYSATOR
 • KAPILLÄRIDIALYSAATTORI
 • DIALIZATOR KAPILARNY
 • KAPILLÄRIS DIALIZÁTOR
 • KAPILÁRNÍ DIALYZÁTOR
 • KAPILÁRAIS DIALIZATORS
 • KAPILLÄRDIALÜSAATOR
 • KAPILIARI DIALIZATORIUS
 S 14521
 2024.08
 CE 2195
 STERILE
 Etropal JSC, Ruski blv191,
 2180 Etropole, Bulgaria
 BLOOD OUTLET

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСЗ 20100703 от 25.05.2010

Иструкция по применению

Описание, содержание, принцип действия. Применение медицинского изделия по назначению. Предостережения. Указания по эксплуатации. Меры предосторожности. Меры безопасности. Меры безопасности при эксплуатации. Меры безопасности при транспортировке. Меры безопасности при хранении. Меры безопасности при утилизации.

Условия хранения: в оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C.

Срок годности: 3 года.

Метод стерилизации: автоклавирование.

Модель: HPS 230

Метод стерилизации: S 14521

Дата стерилизации: 2021.09

М: 2024.08

ЮВЕНТ

Сеторол


Уполномоченный представитель в Российской Федерации: ООО «Ювент Консалтинг», 125167, Российская Федерация, г. Москва, Пресненский проезд д. 4, стреловая 1, 2 этаж, комната 45. Контакт: 8-495-645-55-66, 8-495-645-55-68. E-mail: info@juvent.ru, sales@juvent.ru, www.juvent.ru

Адрес и контактные данные: Бюлвар, гр. Бродово, бldж. София, 091, Руска № 191. Контакт тел: +359 720 634422, факс: +359 720 67094, office@etropal.eu, www.etropal.eu

Место производства медицинского изделия: "Etropal" АД, 2180, Бюлвар, гр. Бродово, бldж. София, 091, Руска № 191


Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с высокой пропускной способностью (HPS), модель: HPS 240

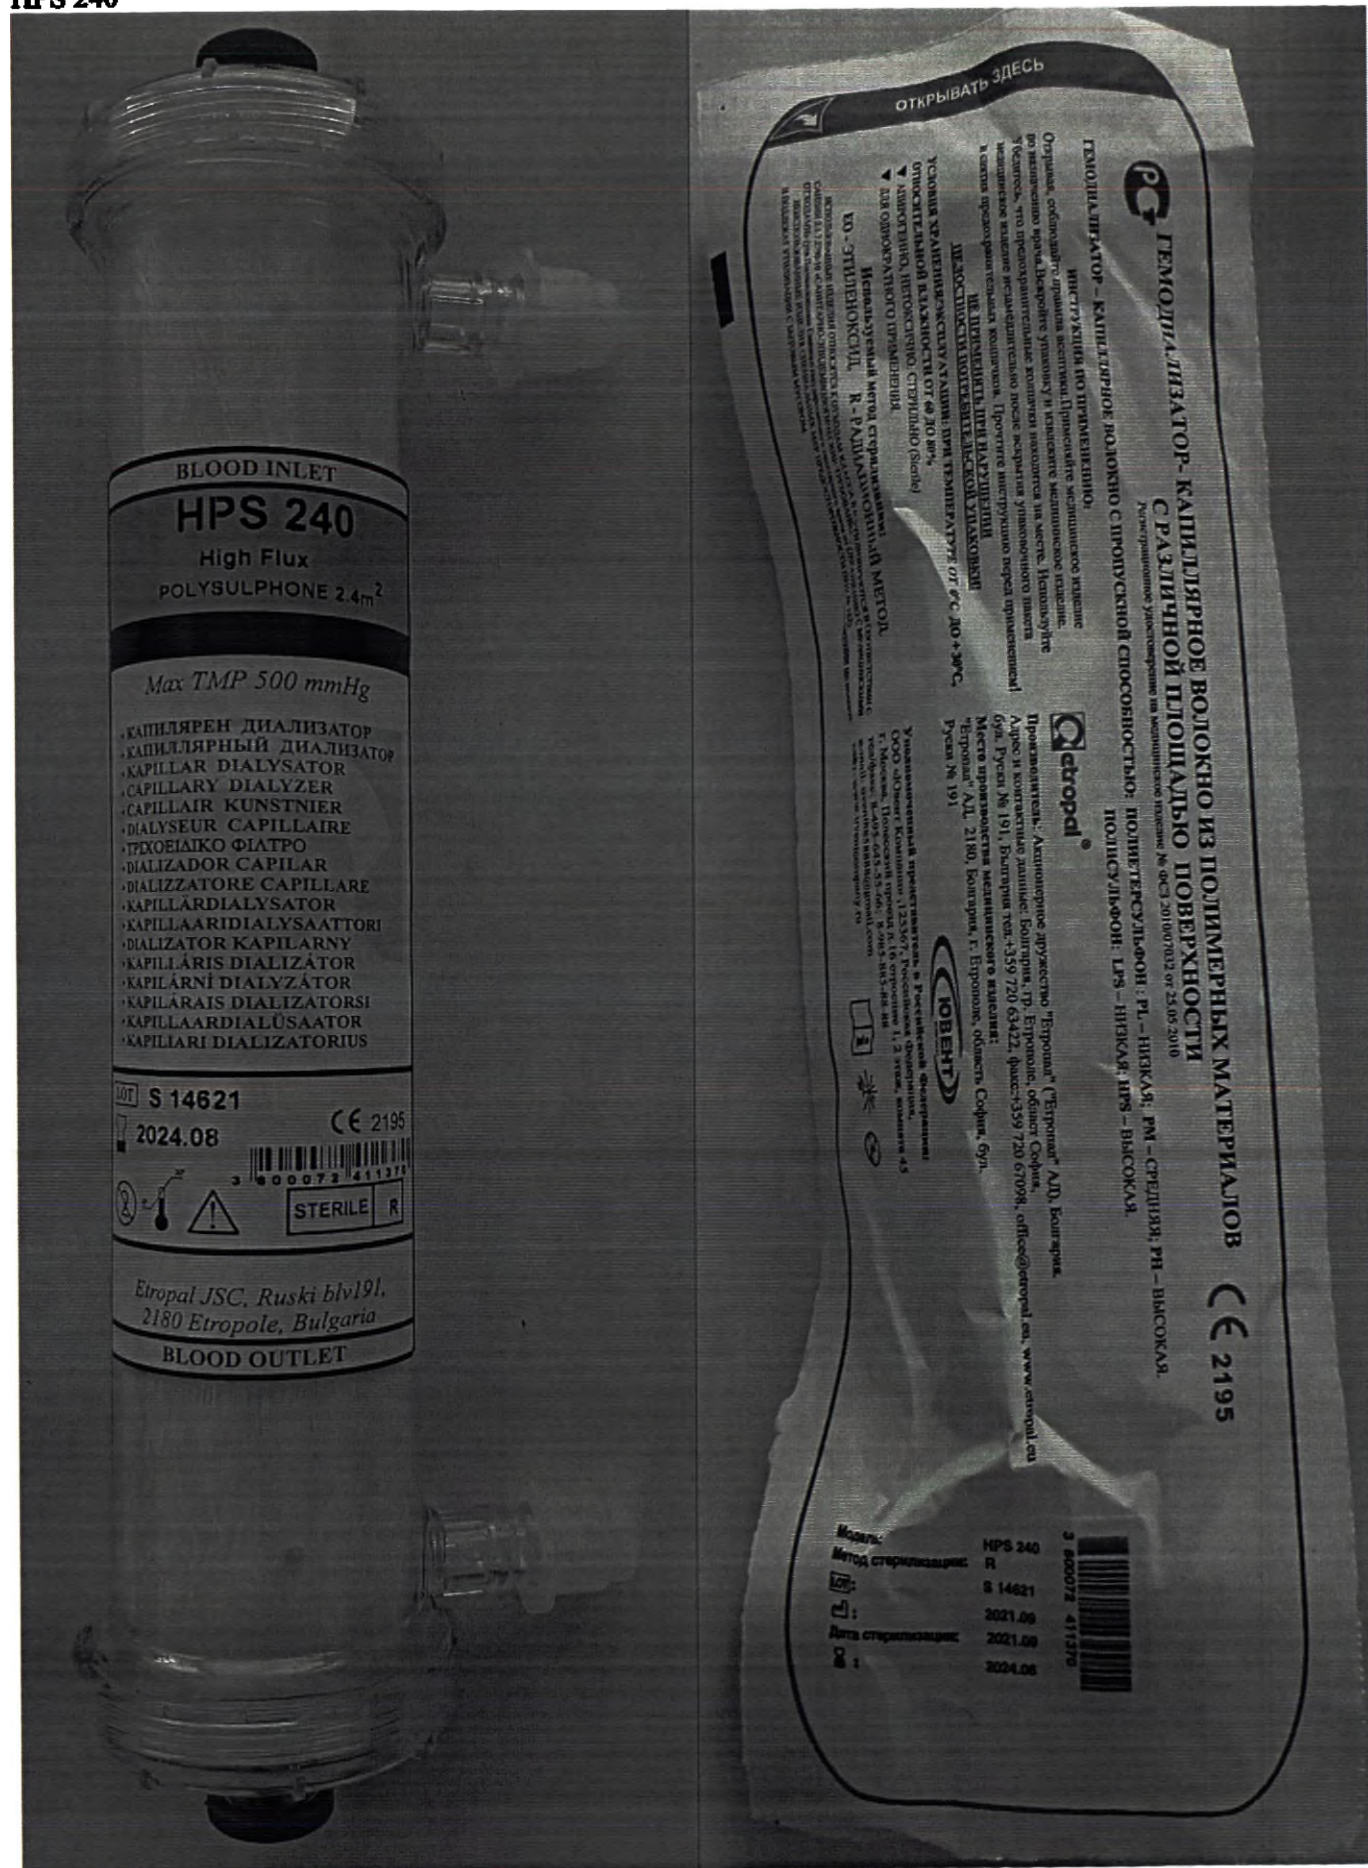


Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с высокой пропускной способностью (HPS), модель: HPS 250

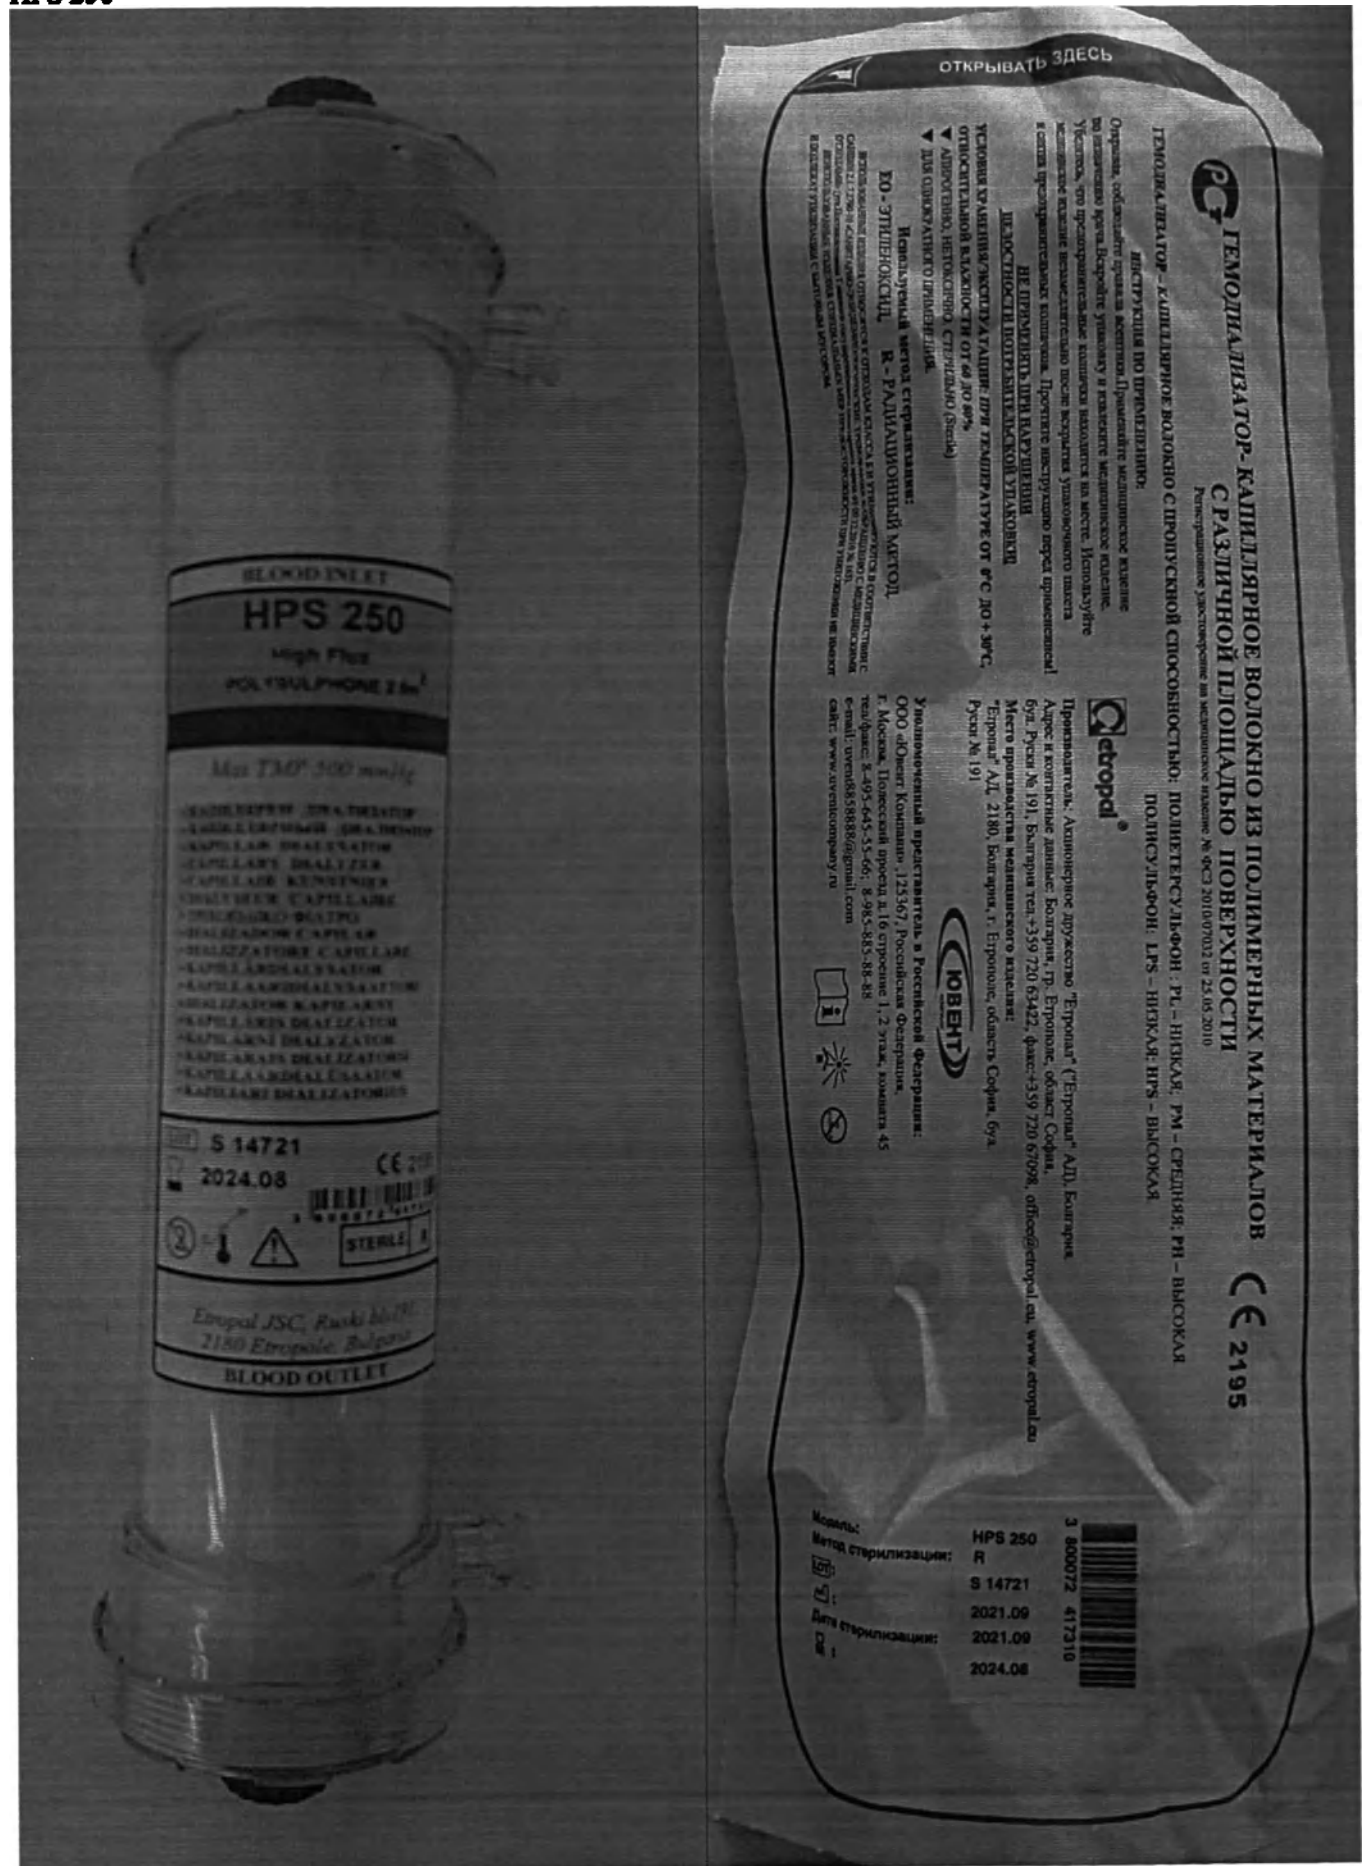


Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с высокой пропускной способностью (HPS), модель: HPS 260

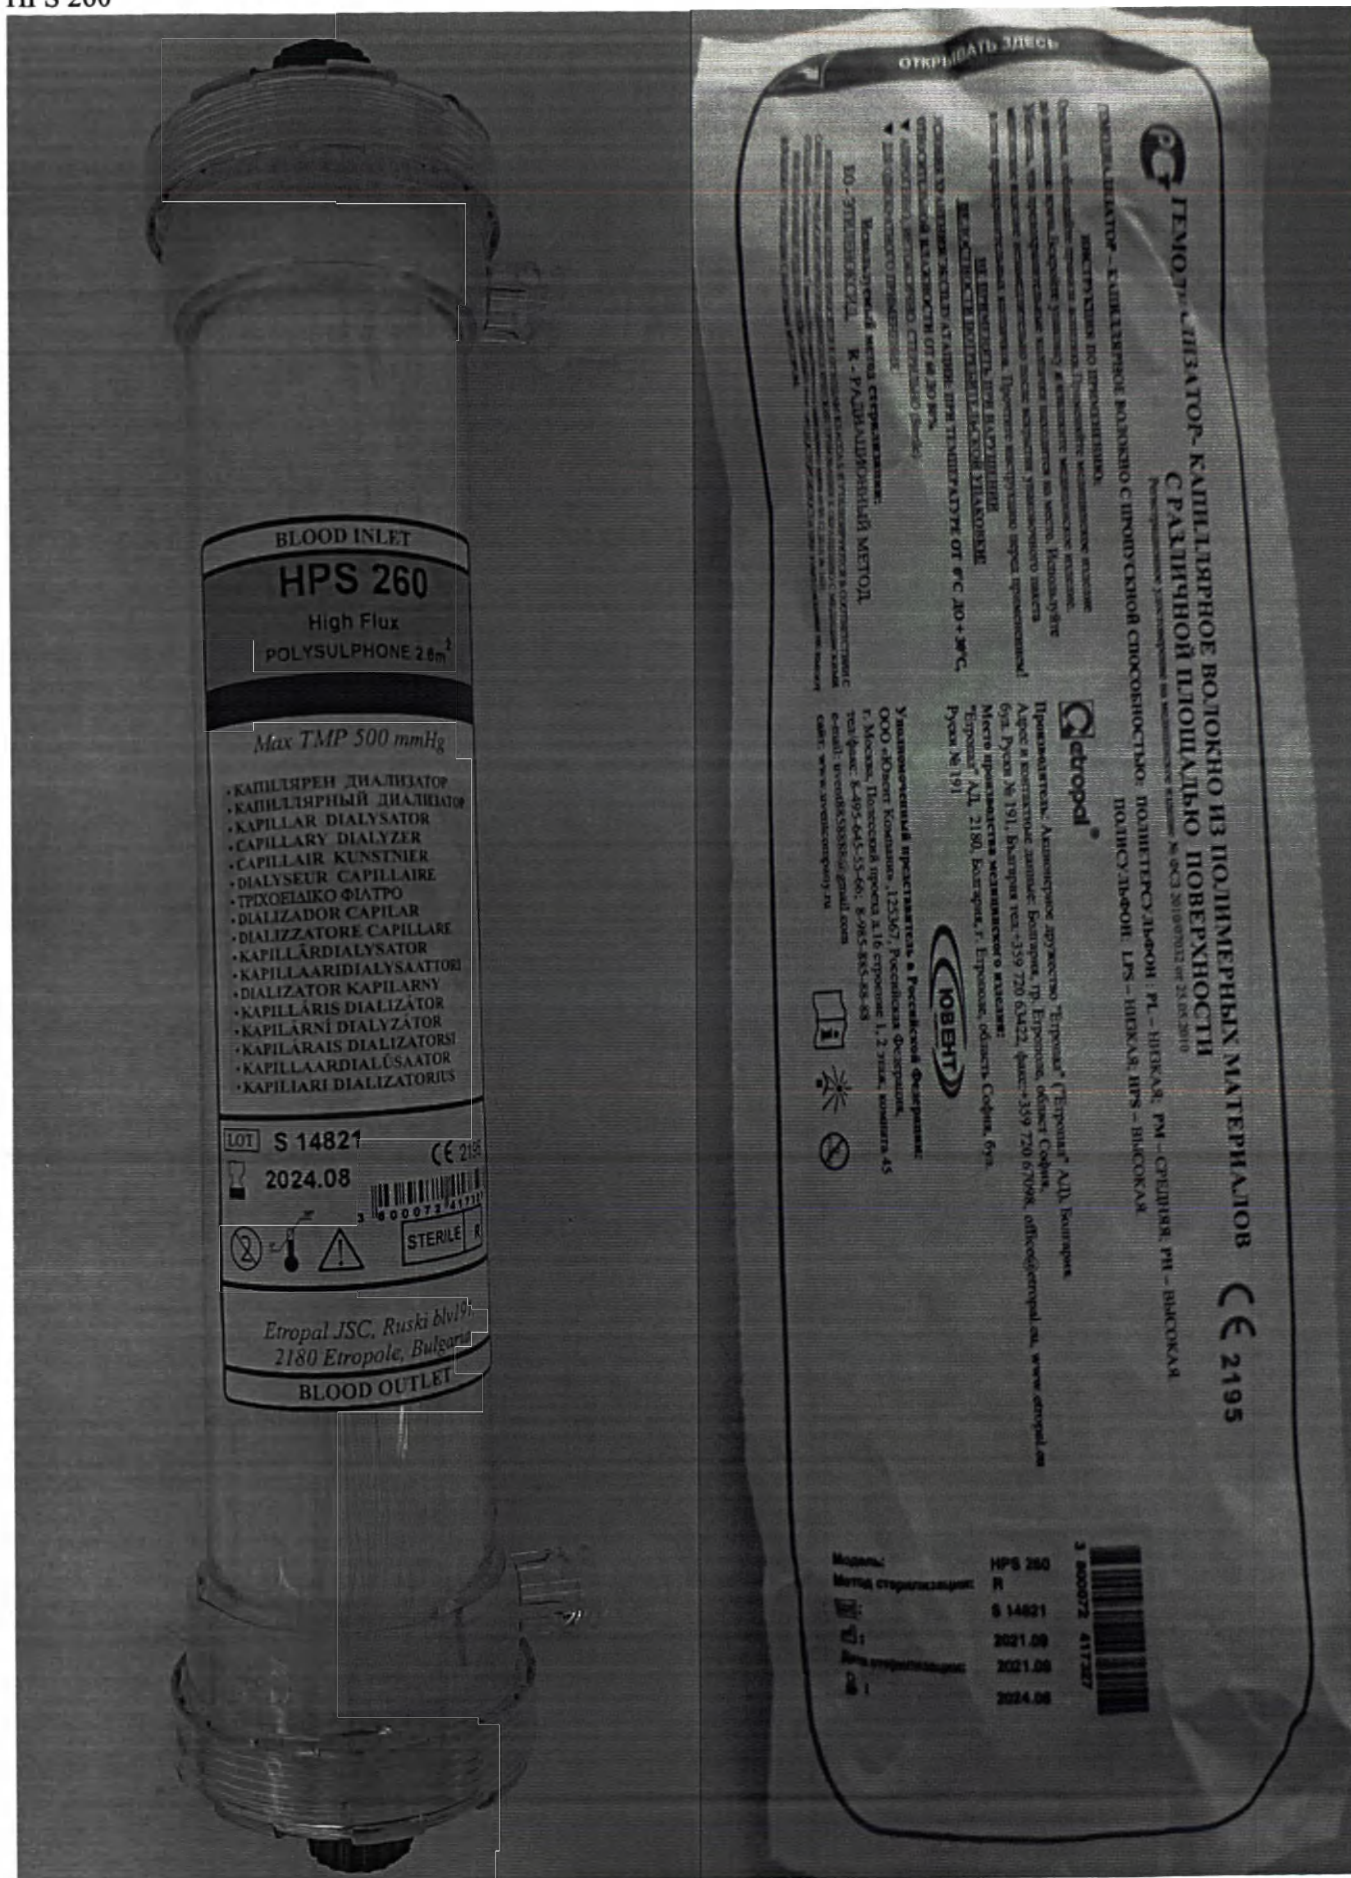


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полисульфон с высокой пропускной способностью (HPS), модель: HPS 270

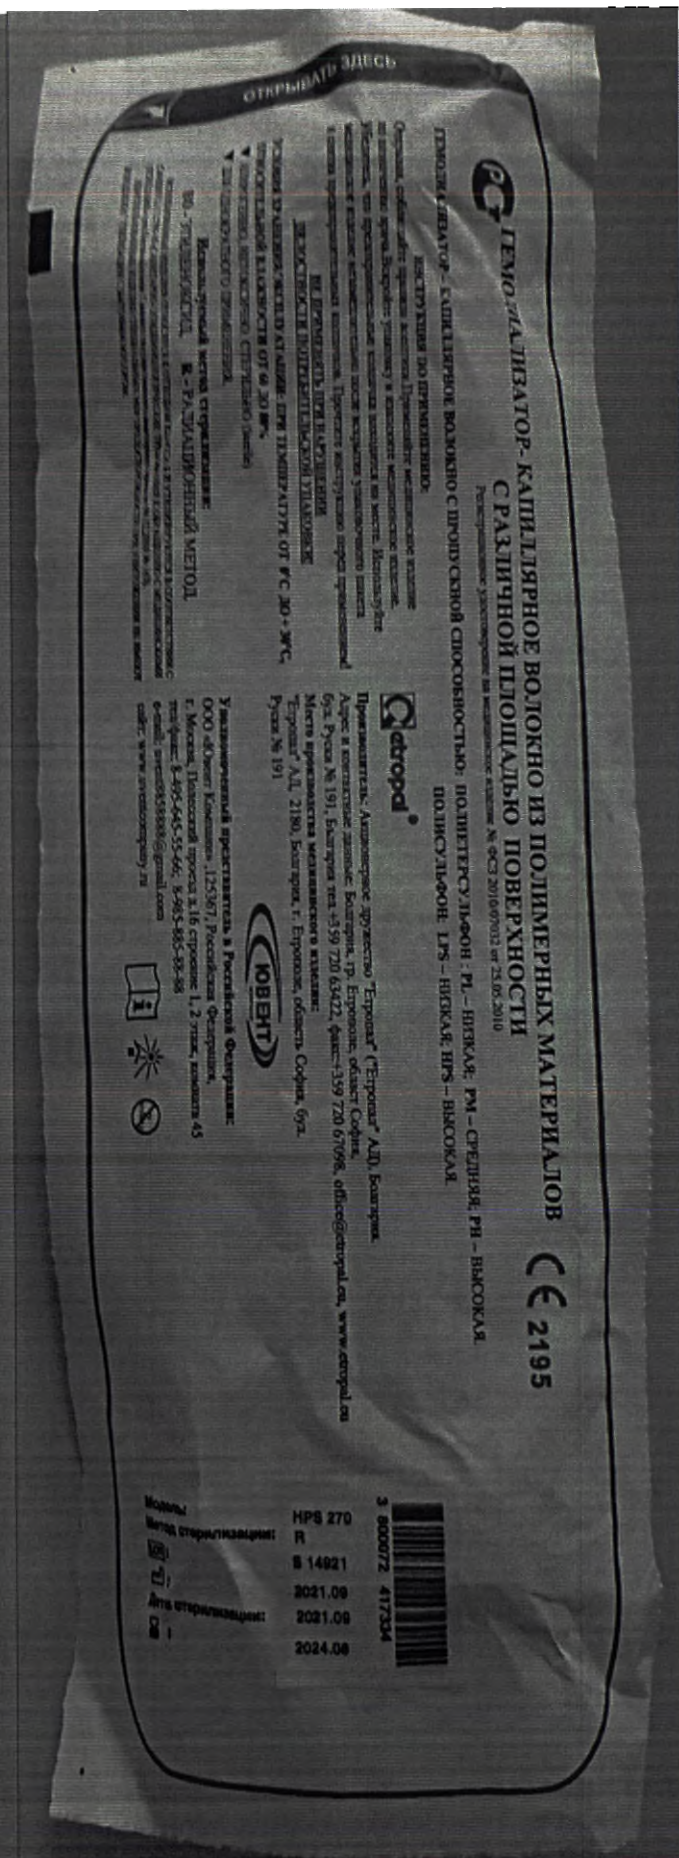


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэtersульфон с низкой пропускной способностью (PL), модель: PL 100

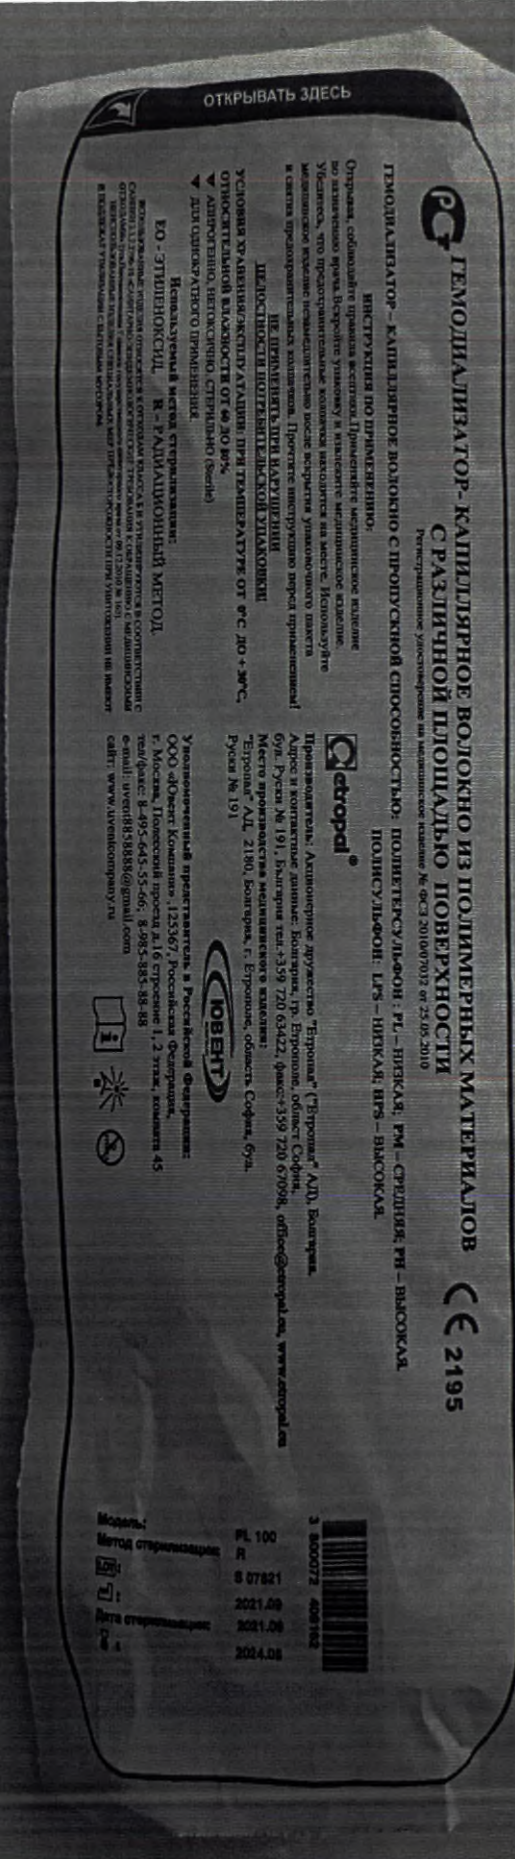


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэtersульфон с низкой пропускной способностью (PL), модель: PL 110

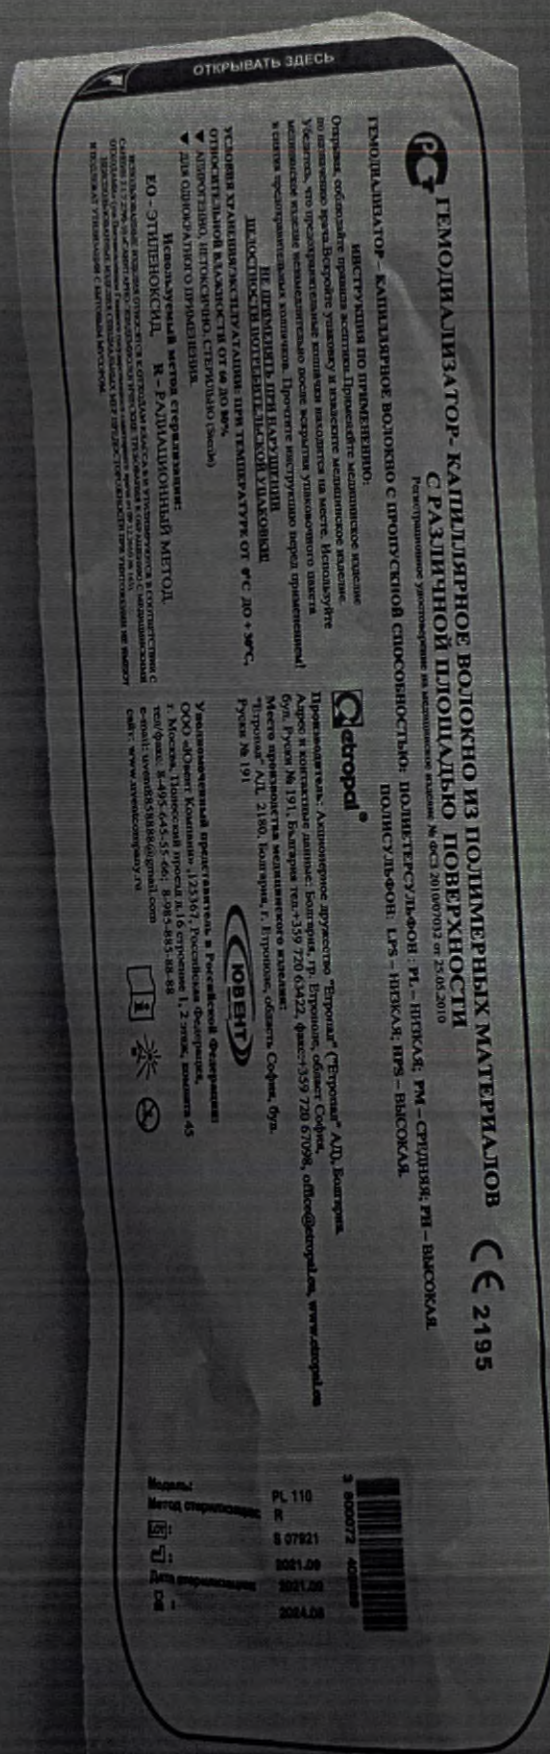


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэtersульфон с низкой пропускной способностью (PL), модель: PL 120

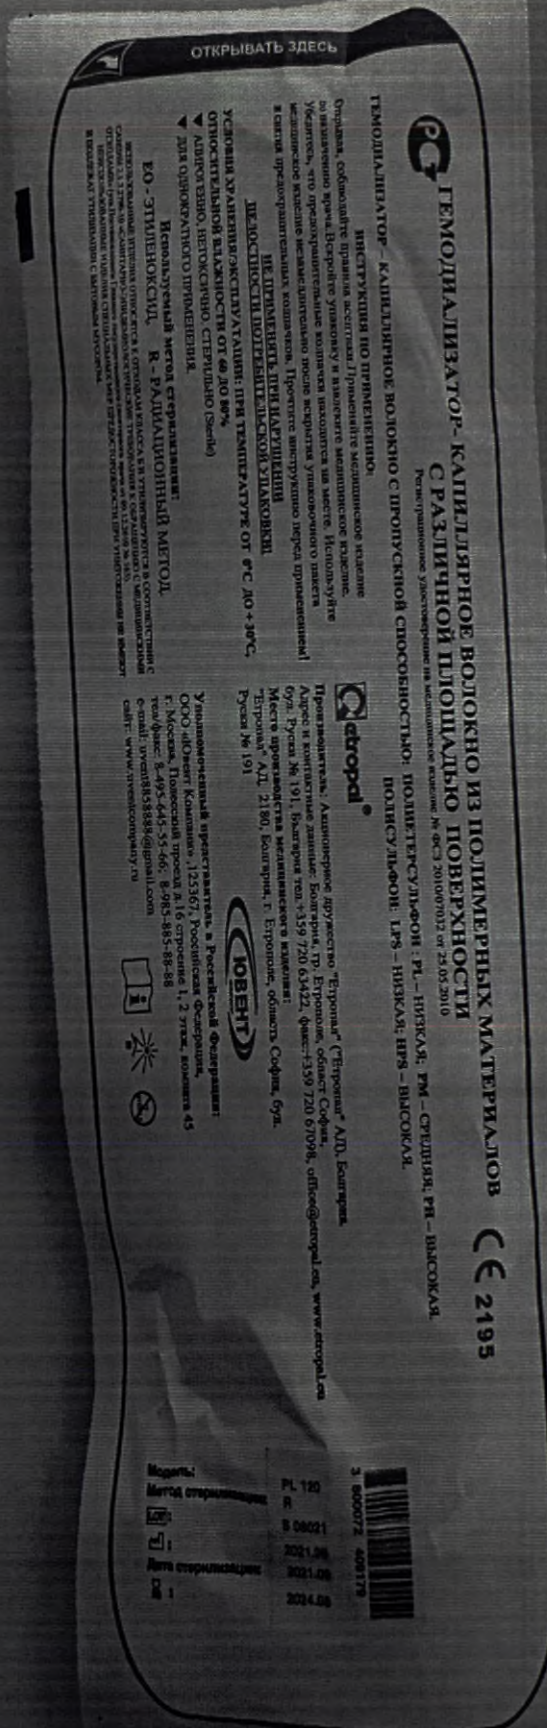

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэtersульфон с низкой пропускной способностью (PL), модель: PL 130

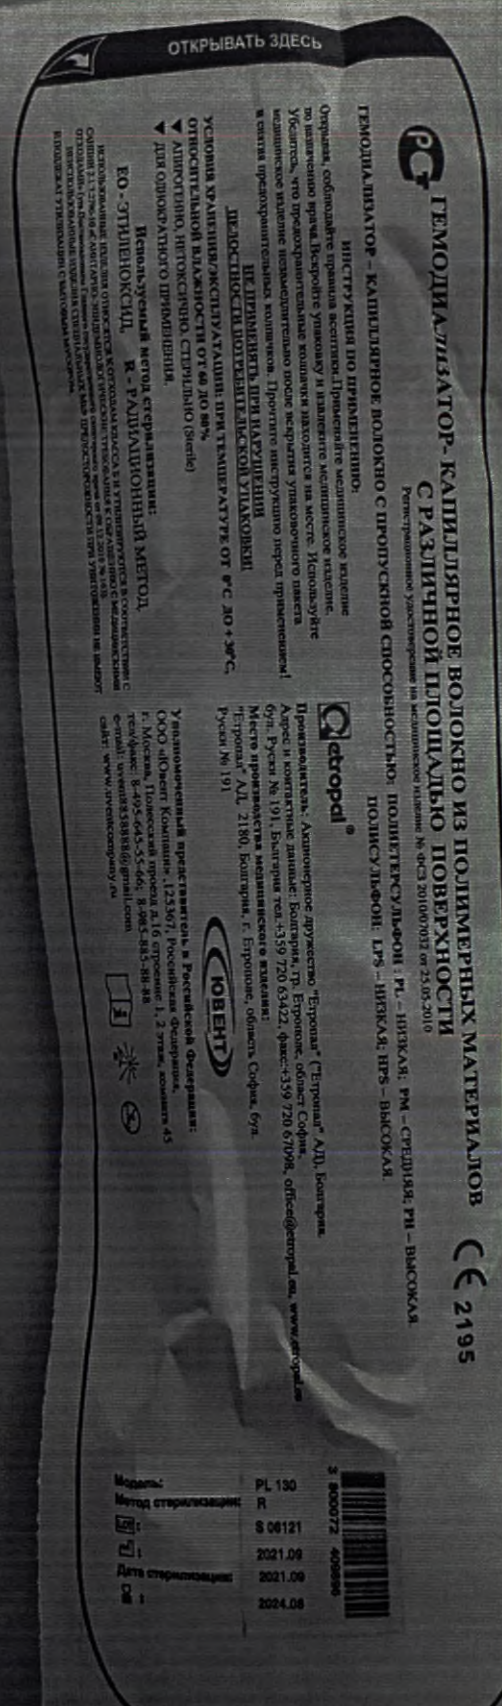


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэtersульфон с низкой пропускной способностью (PL), модель: PL 140

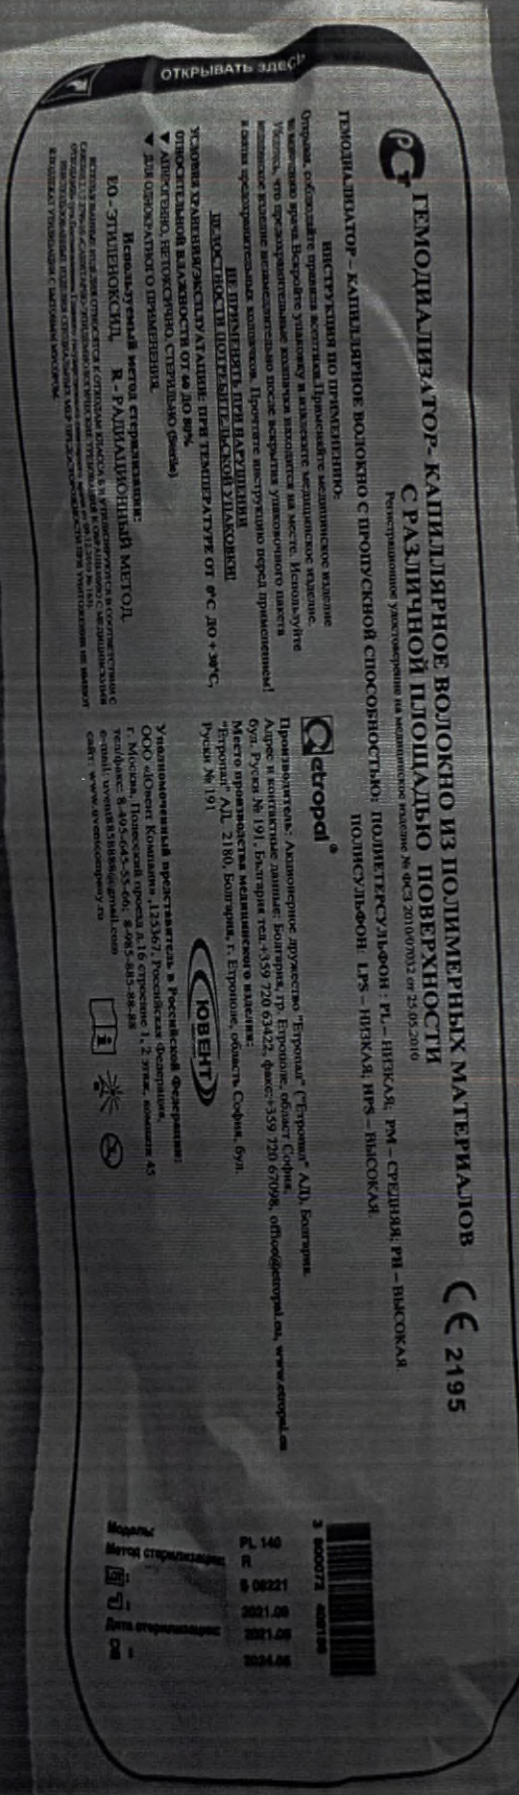


Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэтерсульфон с низкой пропускной способностью (PL), модель: PL 150

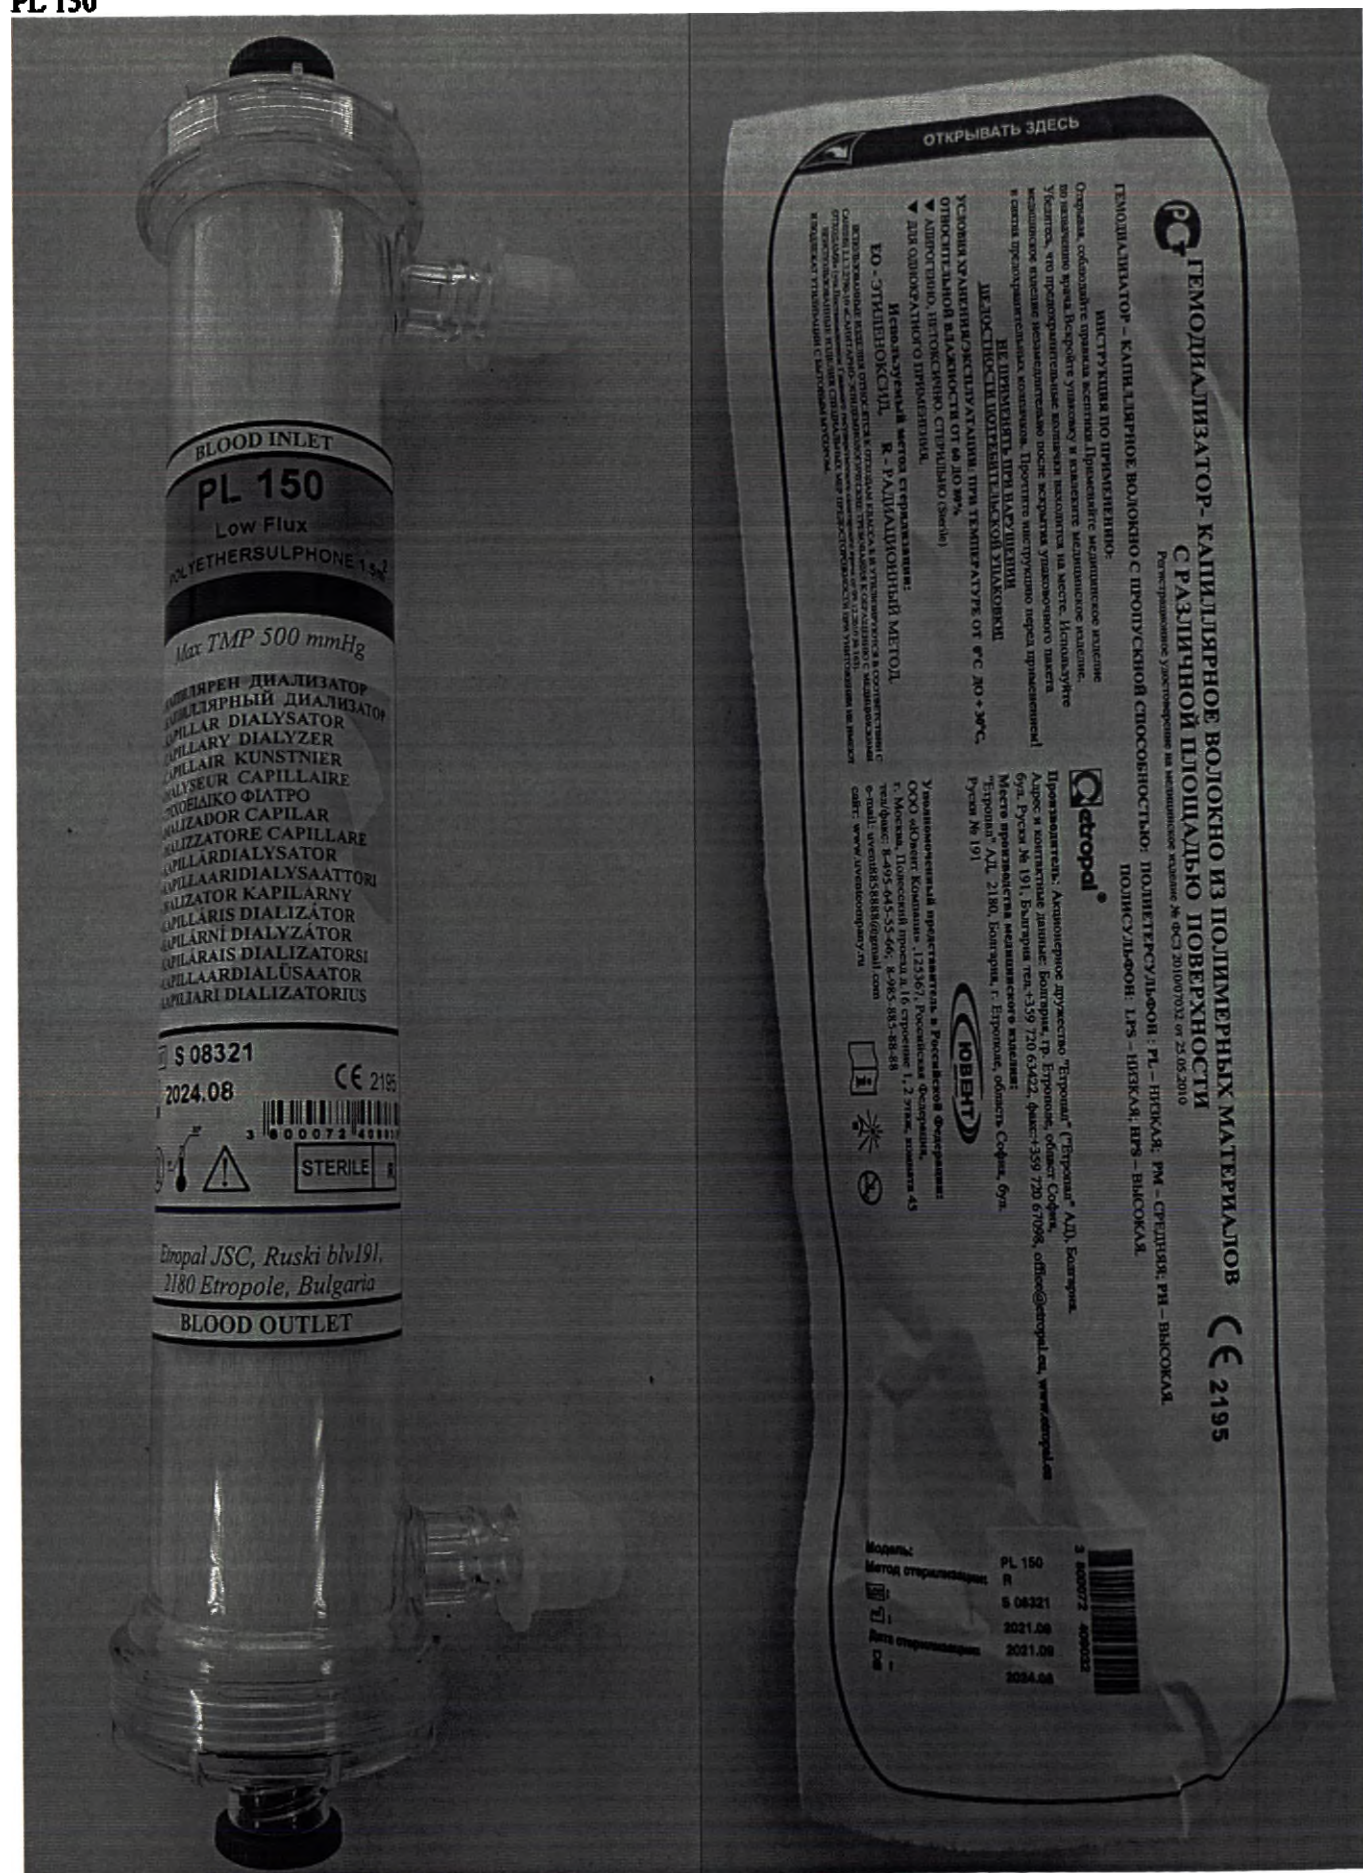

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэtersульфон с низкой пропускной способностью (PL), модель: PL 160

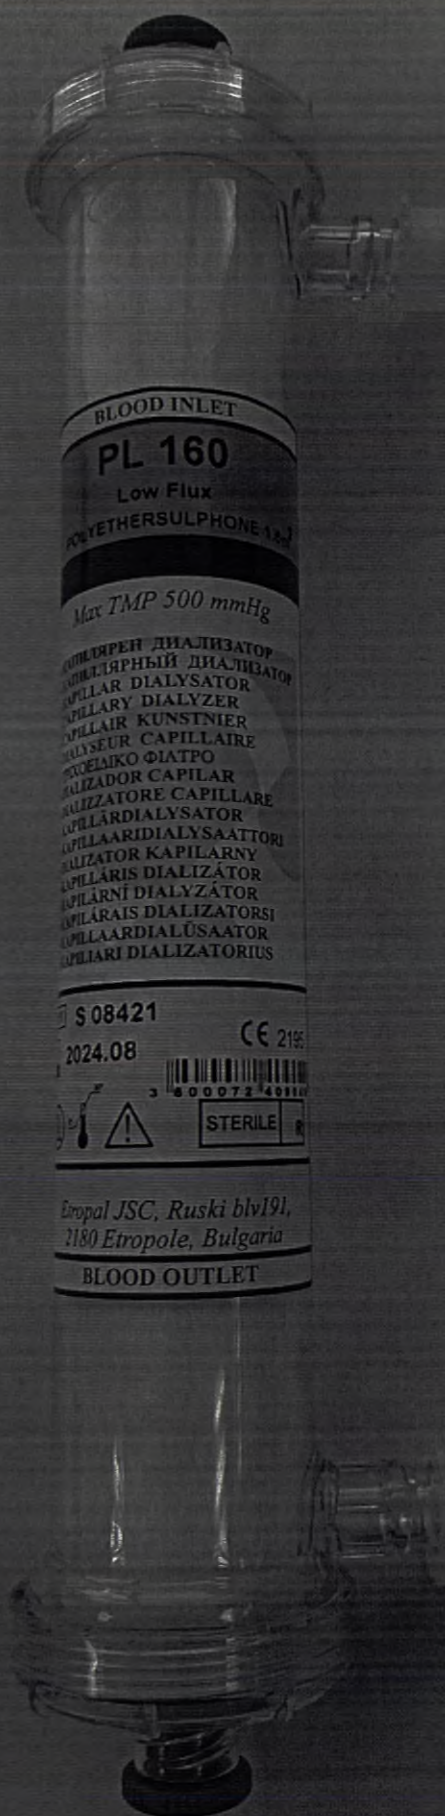

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Р ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЛЯРНОЕ ВОЛОКНО С ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ: ПОЛИЭТЕРСУЛЬФОН: PL - НИЗКАЯ, PM - СРЕДНЯЯ, PN - ВЫСОКАЯ

Инструкция по применению:

Открытая, содержащая препарат, жесткая прозрачная полимерная упаковка. Не вскрывать до момента использования. Убедиться, что препарат не поврежден. После вскрытия упаковки убедиться, что препарат не поврежден. Проверить целостность упаковки перед применением и в случае повреждения упаковки не использовать препарат.

НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ПОКРЫТИЯ ВОЛОКНА

Условия хранения/эксплуатации при температуре от +5°C до +30°C.

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ОТ 60 ДО 80%.

▲ АНТИРОЗЕТНОЕ, НЕТОКСИЧНОЕ СРЕДСТВО

▲ ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Использовать метод стерилизации: ЕО - ЭТНОКОКСИД, R - РАДИКАЦИОННЫЙ МЕТОД.

ВНИМАНИЕ! Гемодиализаторы являются медицинскими изделиями, предназначенными для однократного использования. Не использовать повторно. Не использовать для приготовления растворов. Не использовать для хранения лекарственных средств. Не использовать для приготовления растворов. Не использовать для приготовления растворов. Не использовать для приготовления растворов.

Производитель: Акционерное общество "Булпол" ("Bulpol" AD, Бургас, Бургаская область, Болгария). Адрес и контактные данные: Бургас, ул. Руски блв 191, Бургаская обл. 8010, Бургас. Тел: +359 720 54422, Факс: +359 720 07096, e-mail: info@bulpol.bg, www.bulpol.bg. Место производства медицинского изделия: "Булпол" АД, 2180 Бургас, Бургаская область, Болгария. Риск № 191


Уполномоченный представитель в Российской Федерации: ООО "Цирми", Калужская область, г. Калужа, ул. Советская, д. 40. Тел: +7 495 445 4444, Факс: +7 495 445 4444, e-mail: info@cirmi.ru, www.cirmi.ru

CE 2195

PL 160
R
S 08421
2021.08
2021.08
2024.08

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэтерсульфон с низкой пропускной способностью (PL), модель: PL 170

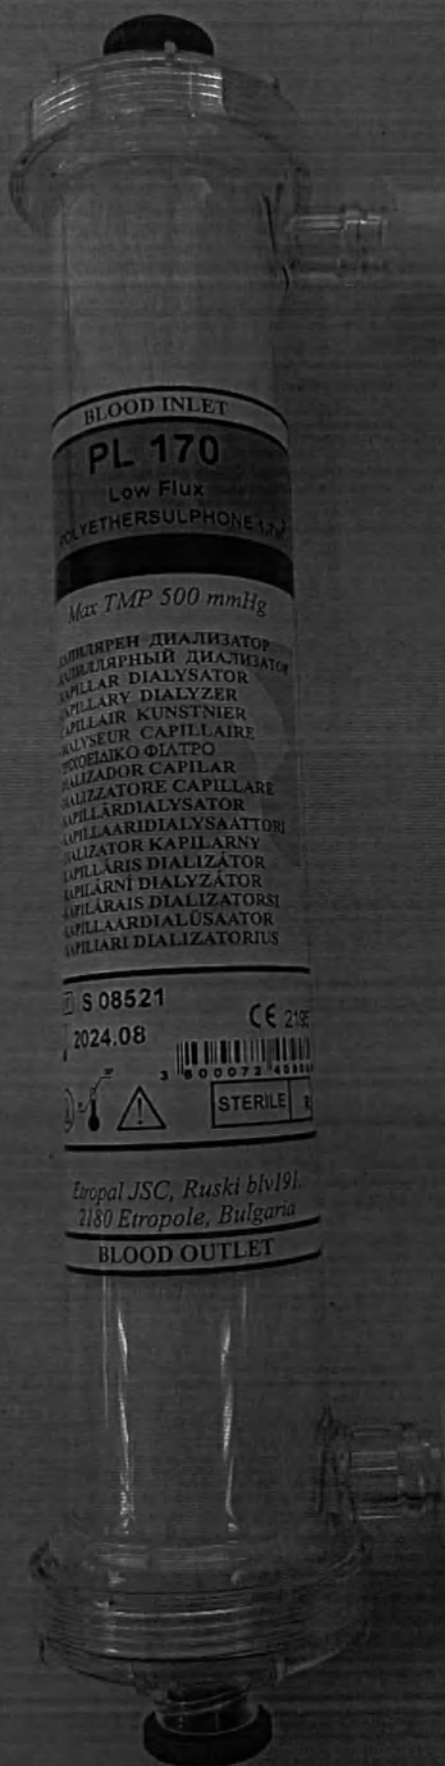

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСЗ 20.10.07032 от 25.05.2010

ПОЛИЭТЕРСУЛЬФОН: PL - НИЗКАЯ, PM - СРЕДНЯЯ, PN - ВЫСОКАЯ

ПОЛИСУЛЬФОН: LPS - НИЗКАЯ, NPS - ВЫСОКАЯ

CE 2195

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Описание, особенности, правила эксплуатации. Прочитайте инструкцию в течение 10 минут после вскрытия упаковки и вставьте медицинское изделие в аппарат. Проверьте, что все детали правильно соединены. Проверьте, что все детали правильно соединены. Проверьте, что все детали правильно соединены.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Храните изделие при температуре от +5°C до +25°C.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ: От 60% до 80%.

АДРЕС: НИЗКОПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ (Low Flux).

Использование метода стерилизации: В-РАДИАЦИОННЫЙ МЕТОД.

ЕО - СТИРЕНКОКСИД: В-РАДИАЦИОННЫЙ МЕТОД.

ВНИМАНИЕ! Не используйте изделие после истечения срока годности, указанного на упаковке. Не используйте изделие после истечения срока годности, указанного на упаковке.

отрорд

Продукция: Аппаратное устройство "Европол" (Европол) АД, Болгария.

Адрес: Компетентная лаборатория: Болгария, гр. Вроча, община София, бул. "България" № 191, Болгария тел: +359 720 63422, факс: +359 720 67096, e-mail: info@otord.com, web: www.otord.com

Место производства: Медицинское изделие: "Европол" АД, 2180, Болгария, гр. Вроча, община София, бул. "България" № 191

Уполномоченный представитель в Российской Федерации: ООО "Юсмент Коммента", 123167, Российская Федерация, г. Москва, Псковский проезд д. 10, 10-й этаж, к. 45, телефон: 8-495-645-45-66, факс: 8-495-645-45-67, e-mail: info@yusment.com, web: www.yusment.com

Модель: PL 170

Материал: PM

Срок годности: 3621.00

Дата окончания: 3021.00

3024.00

3 800072 40004

PL 170

PM


S 08521

3621.00

3021.00

3024.00

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэтерсульфон с низкой пропускной способностью (PL), модель: PL 180

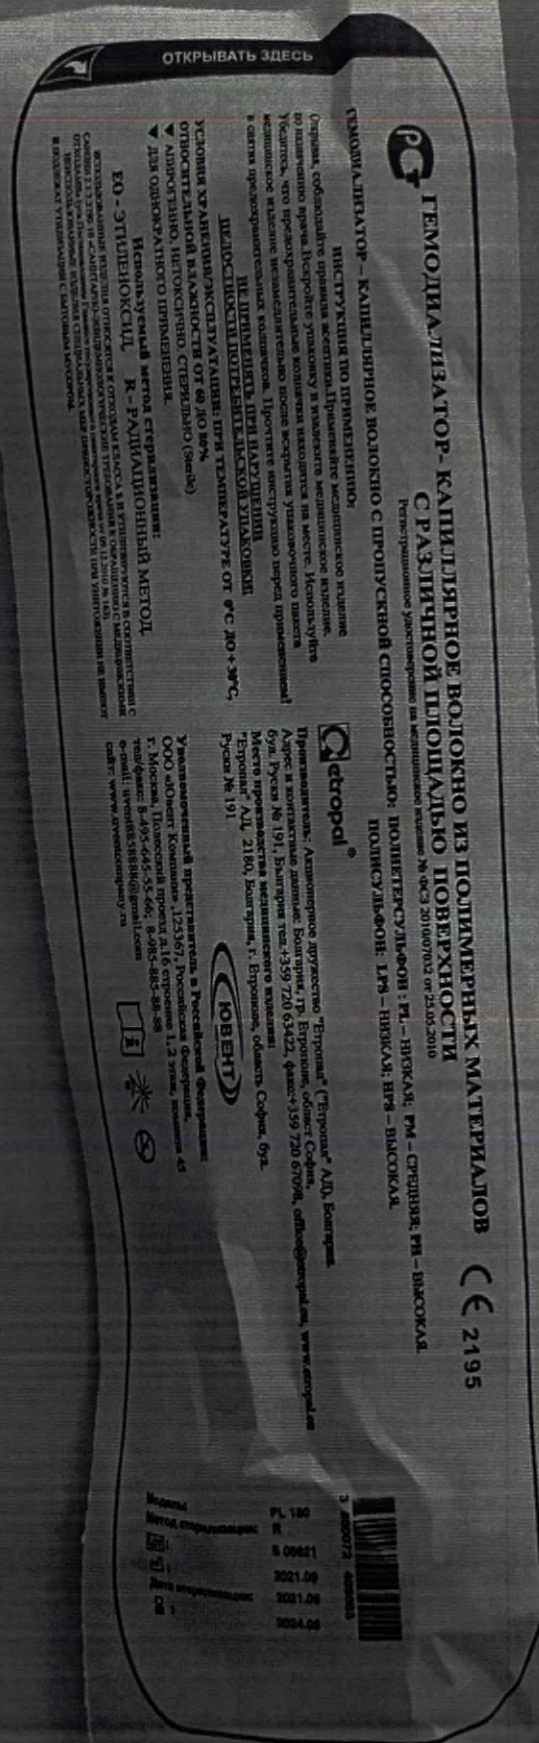

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэтерсульфон с низкой пропускной способностью (PL), модель: PL 190



ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

PL ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

Краткое описание устройства: PL - ПЕРЕСАДКА, РМ - СРЕДНЯЯ, РН - ВЫСОКАЯ, ПОЛИЭТЕРСУЛФОН: LPS - НИЗКАЯ, HPS - ВЫСОКАЯ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Оверлей, обеспечивающий защиту от инфекции, применяется для предотвращения перекрестной контаминации. При применении мембраны необходимо соблюдать следующие правила: избегать контакта с агрессивными веществами, избегать контакта с острыми предметами, избегать контакта с горячими жидкостями.

Условия хранения: температура от +2 до +25°C, относительная влажность от 60 до 90%.

Адрес: 1901, Бургария, София, ул. Руски блв. 191, телефон: +359 720 63422, факс: +359 720 67098, e-mail: info@etropal.com, www.etropal.com

Место производства: мембранное производство, "Европол" АД, 2180, Бургария, г. Етрополе, община София, Бун. Руски блв 191

Упаковочный материал: полиэтиленовый пакет, в котором находится гемодиализатор.


ООО "Этропол" Компания, 125160, Российская Федерация, г. Москва, Пресненский район, ул. Басовская, д. 10, стр. 1, 2 этаж, код почтовый 125160, телефон: +7 495 454 54 56, факс: +7 495 454 54 58, e-mail: info@etropal.ru, www.etropal.ru

Etropal JSC, Ruski blv191, 2180 Etropole, Bulgaria


CE 2195

Модель: PL 190
 Номер стерилизации: S 06721
 Дата стерилизации: 2021.08
 Дата изготовления: 2024.08


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсульфон с низкой пропускной способностью (PL), модель: PL 200

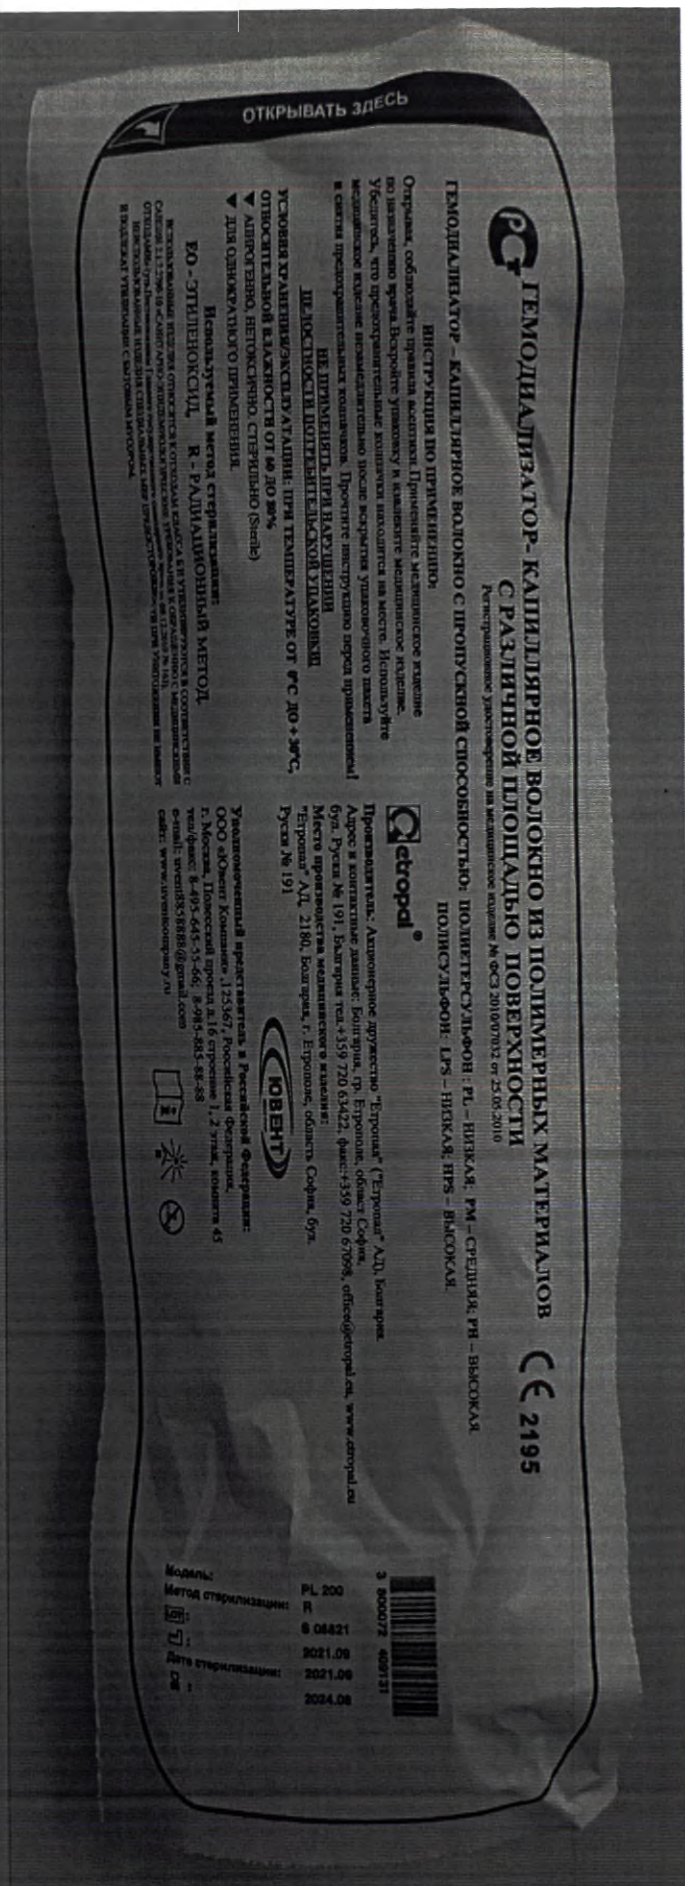


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэtersульфон с низкой пропускной способностью (PL), модель: PL 210

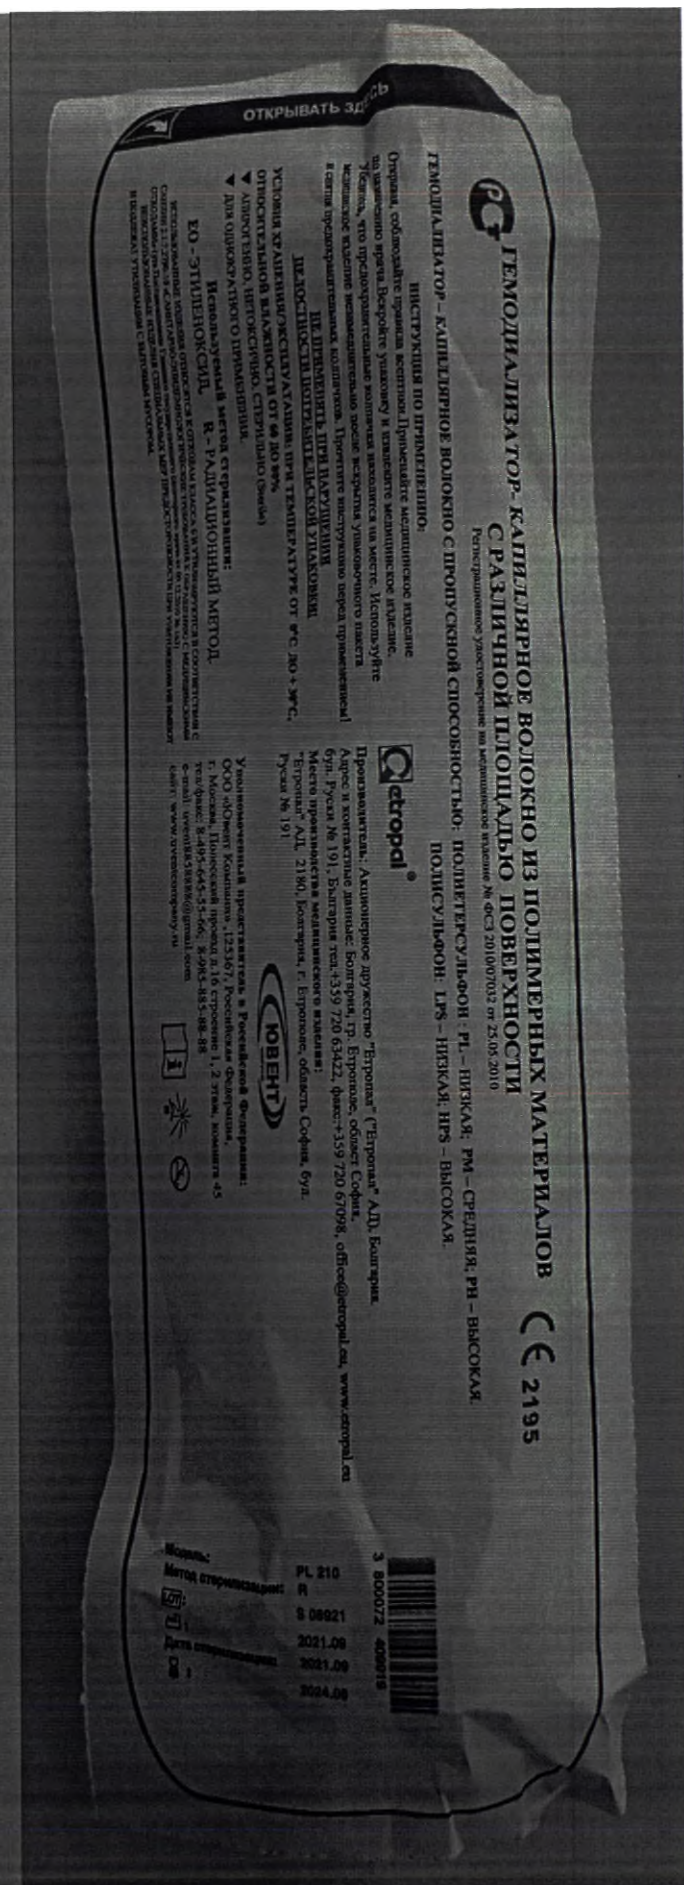

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсульфон с низкой пропускной способностью (PL), модель: PL 220

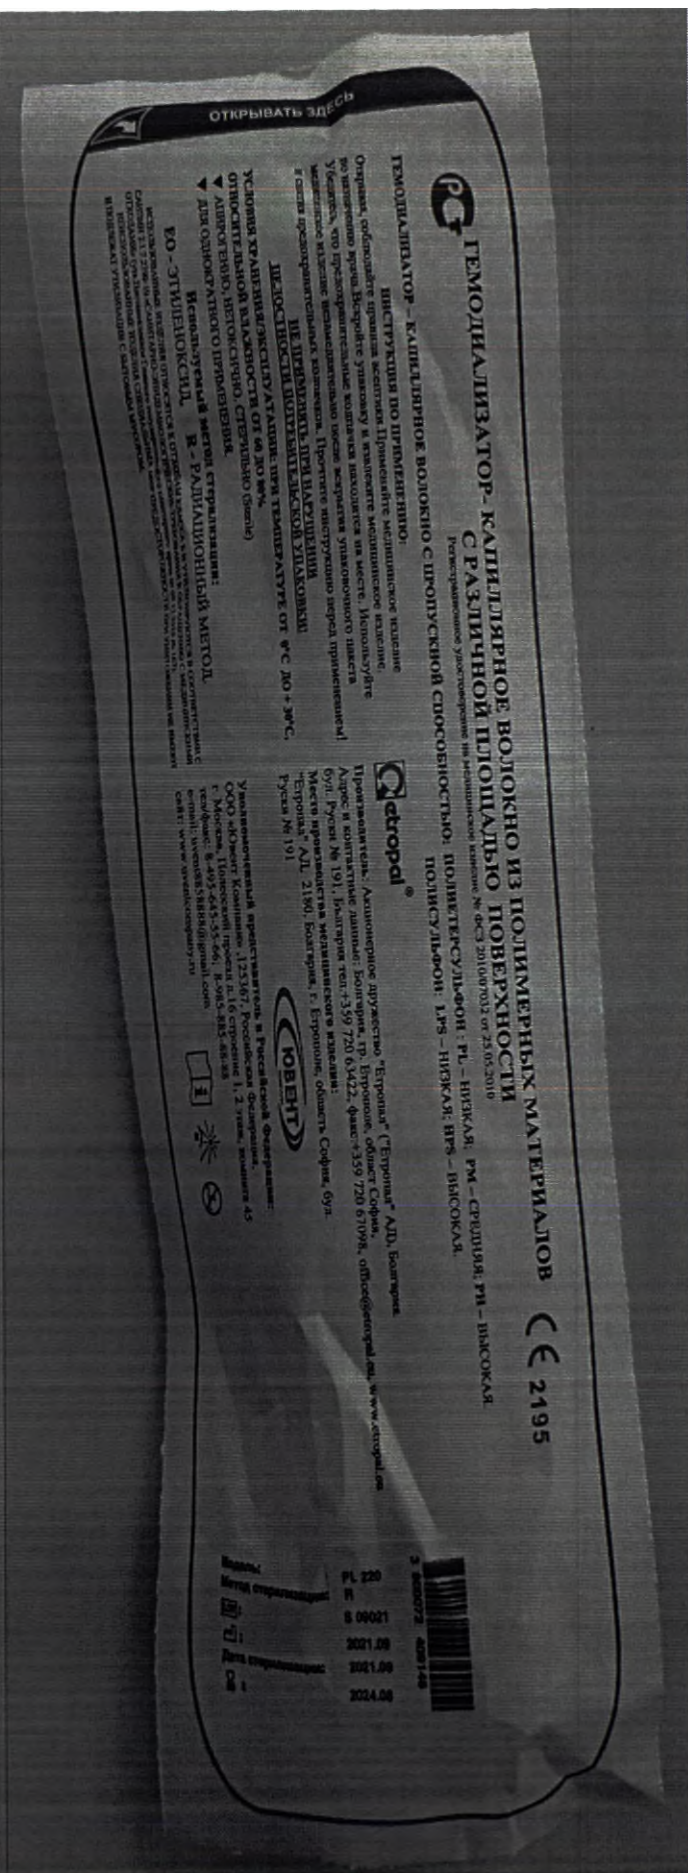


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсульфон с низкой пропускной способностью (PL), модель: PL 230

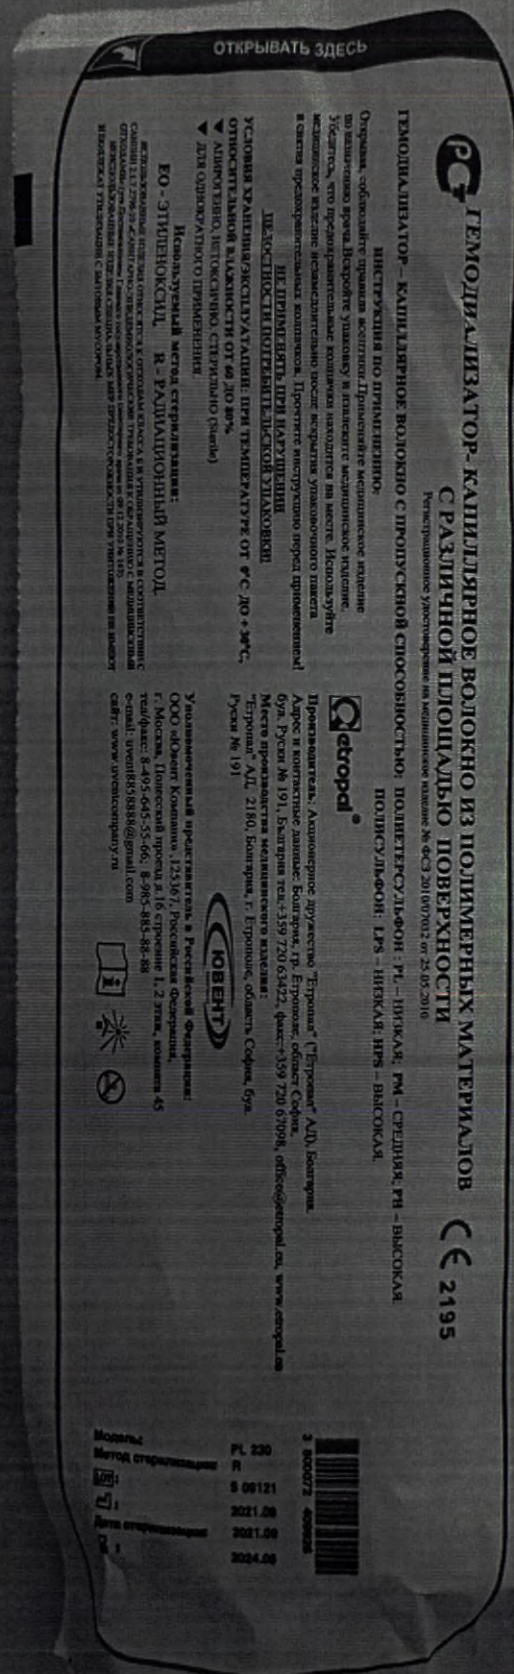

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэтерсульфон с низкой пропускной способностью (PL), модель: PL 240

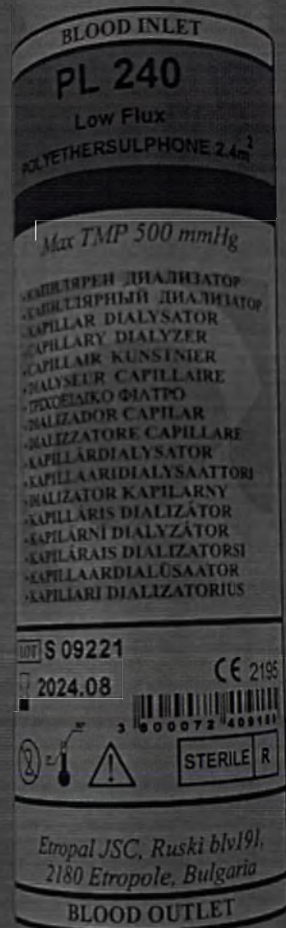

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № 06C1.201.007032 от 25.05.2010

ПОЛИЭТЕРСУЛЬФОН : PL - НИЗКАЯ, PM - СРЕДНЯЯ, PN - ВЫСОКАЯ.

ПОЛИСУЛЬФОН: LPS - НИЗКАЯ, HPS - ВЫСОКАЯ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Оригиналы, содержащие права на изобретение. Применять медицинское изделие по назначению врача-нефролога, учитывая и соблюдать медицинское изделие. Убедиться, что предохранительные колпачки наконечников на месте. Исключить использование изделия, если наконечники после вскрытия упаковки имеют поврежденную целостность или повреждены. Проверить инструкцию перед применением!

НЕ ПРИБЛИЖАТЬ КРУПНОКАПЕЛЬНЫМ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ/ЭКСПЛУАТАЦИИ: ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 0°C ДО +30°C.

ОПТИМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ОТ 60 ДО 80%.

ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Исключительный метод стерилизации:

EO - ЭТИЛЕНОКСИД, R - РАДИКАЦИОННЫЙ МЕТОД.

Упаковка, содержащая информацию о стерилизации, должна быть сохранена и использоваться в соответствии с инструкцией. Упаковка должна быть открыта непосредственно перед применением. После вскрытия упаковки изделие должно использоваться немедленно. Не использовать изделие, если упаковка повреждена или повреждена информация на упаковке.

Этропол®

Производитель: Акционерное общество "Этропол" АД, Болгария.

Адрес и контактные данные: Болгария, гр. Етрополе, община София, бул. Руски № 191, България тел: +359 720 63422, факс: +359 720 67098, office@etroportal.eu, www.etroportal.eu

Место производства медицинского изделия "Этропол" АД, 2180, Болгария, гр. Етрополе, община София, бул. Руски № 191

Уполномоченный представитель в Российской Федерации: ООО «Объект Консалтинг», 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 16, строповые 1, 2-й этаж, комната 45, тел: +7 (495) 445-53-66, 8-905-815-88-88, e-mail: info@obekt.ru, www.obekt.ru

Импортёр: ООО «Цирми», 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 16, строповые 1, 2-й этаж, комната 45, тел: +7 (495) 445-53-66, 8-905-815-88-88, e-mail: info@cirmi.ru, www.goszdravnadzor.ru

Модель: PL 240

Метод стерилизации: R

№: S 09221


Дата изготовления: 2021.08

Дата истечения срока годности: 2024.08

3 600072 408155


Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсульфон с низкой пропускной способностью (PL), модель: PL 250


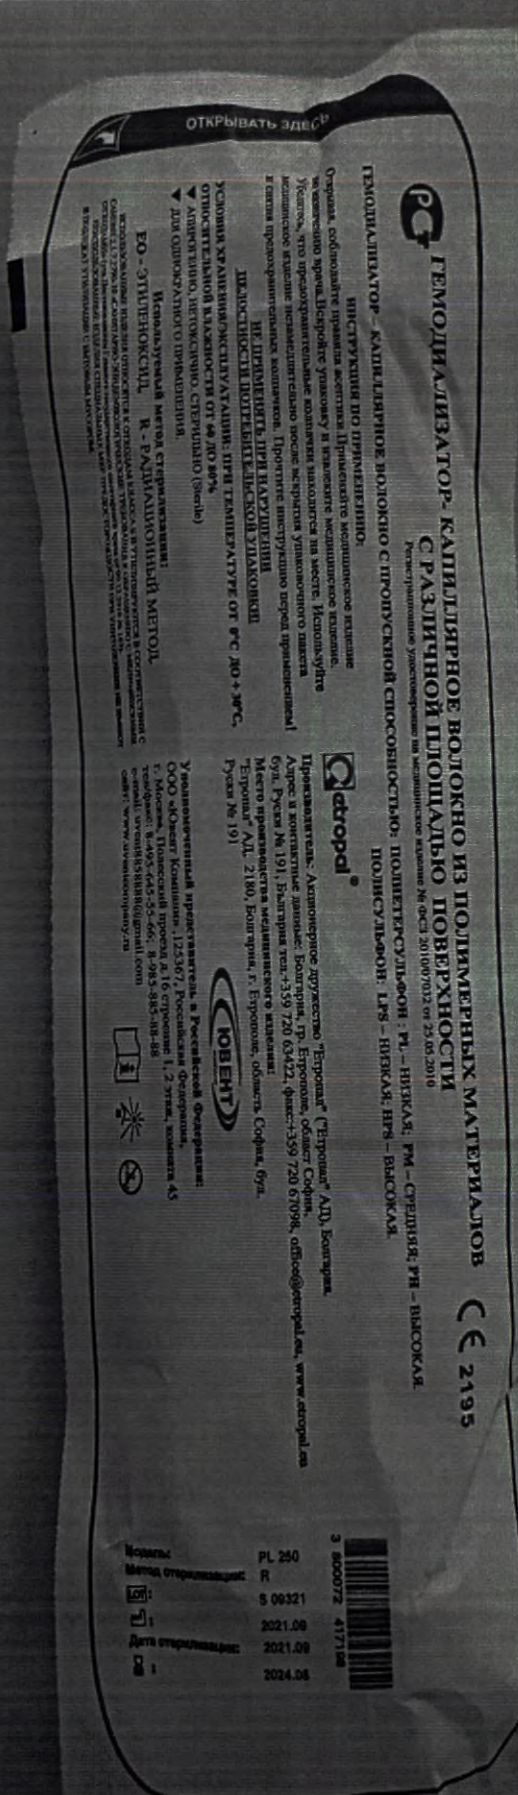


Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, варианты исполнения:


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэтерсульфон с низкой пропускной способностью (PL), модель: PL 260

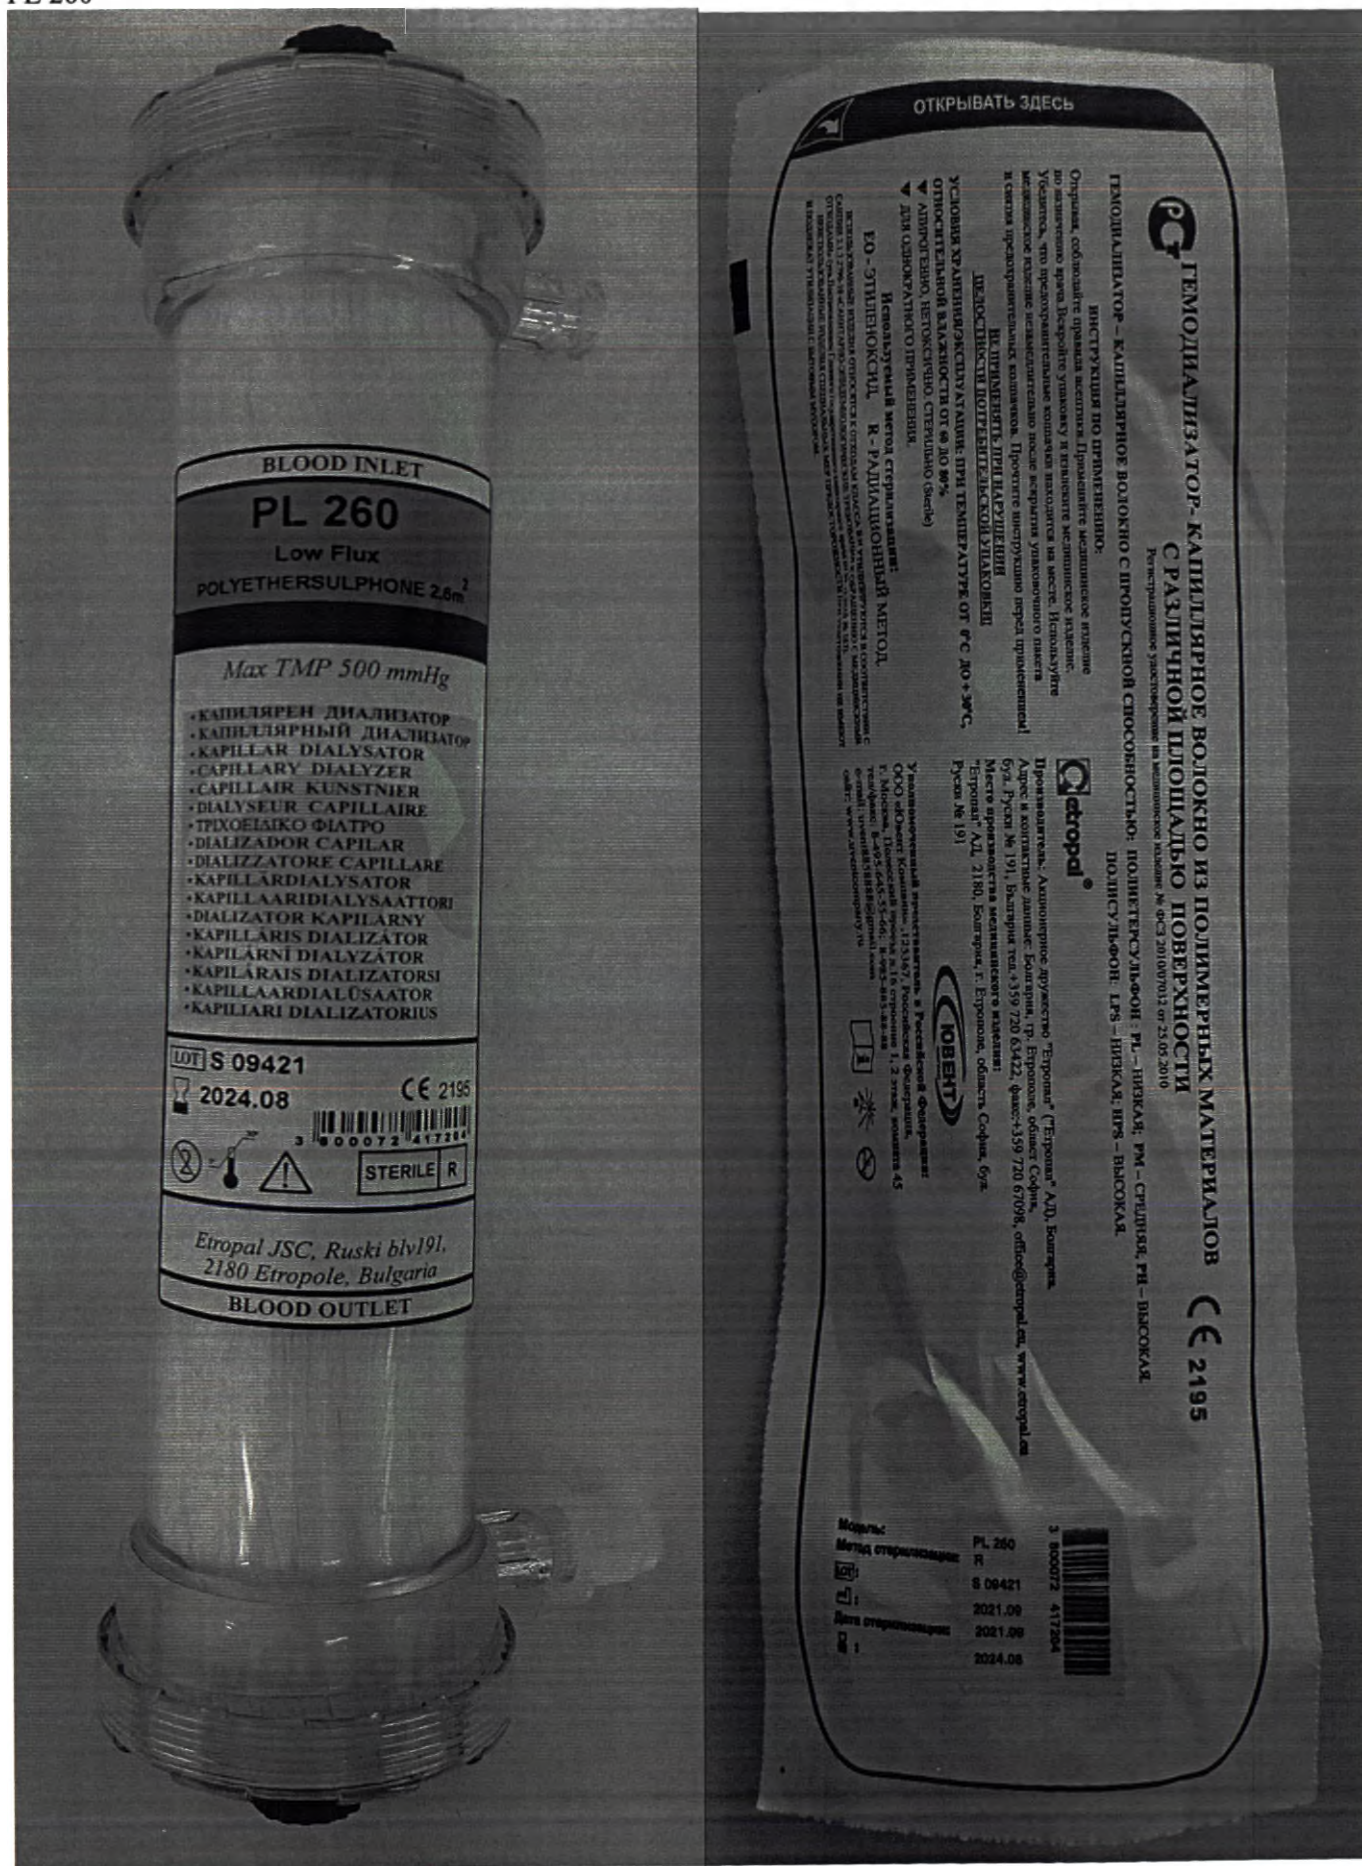

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиметерсульфон с низкой пропускной способностью (PL), модель: PL 270

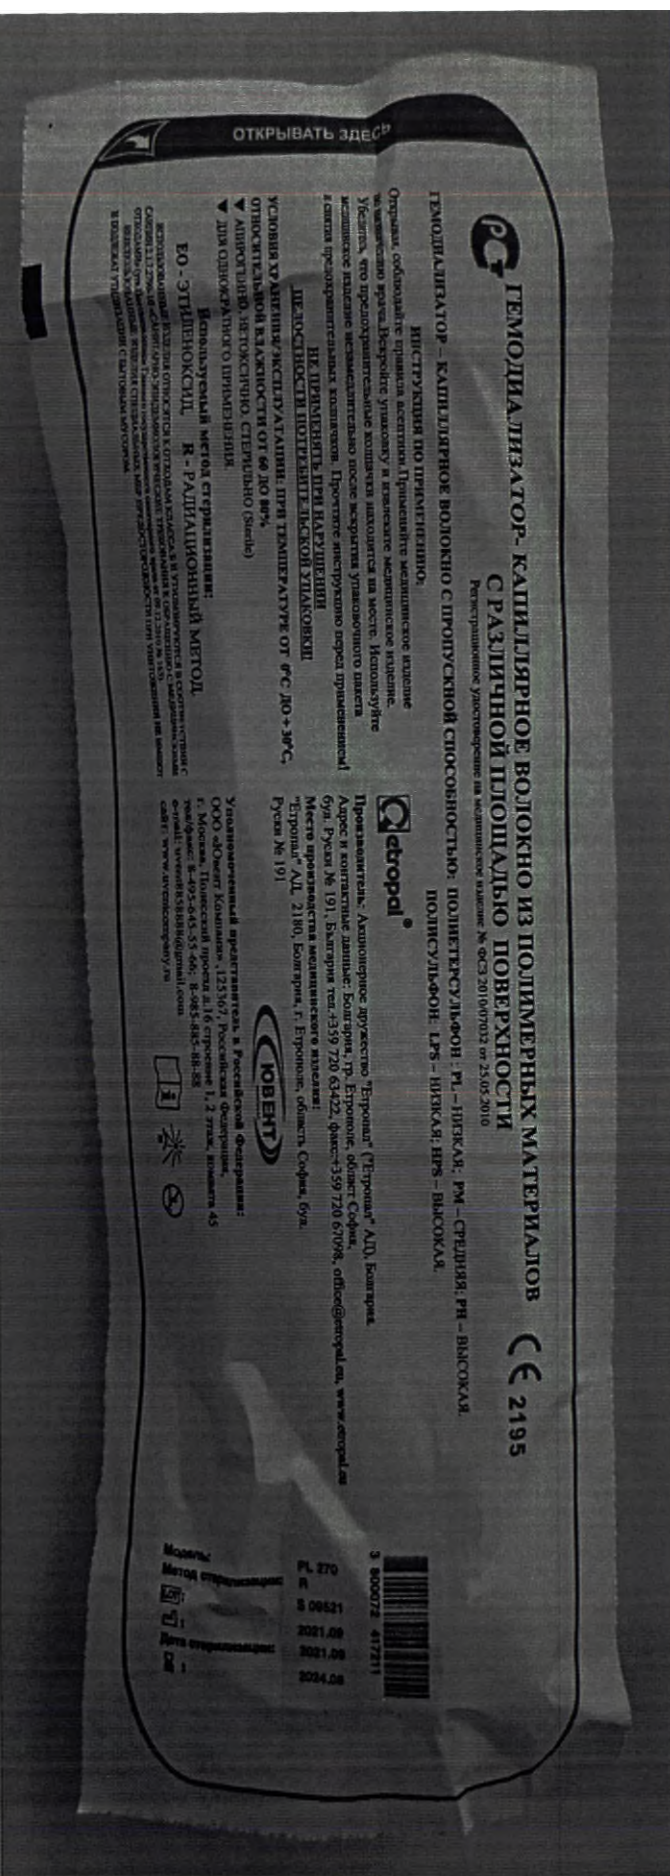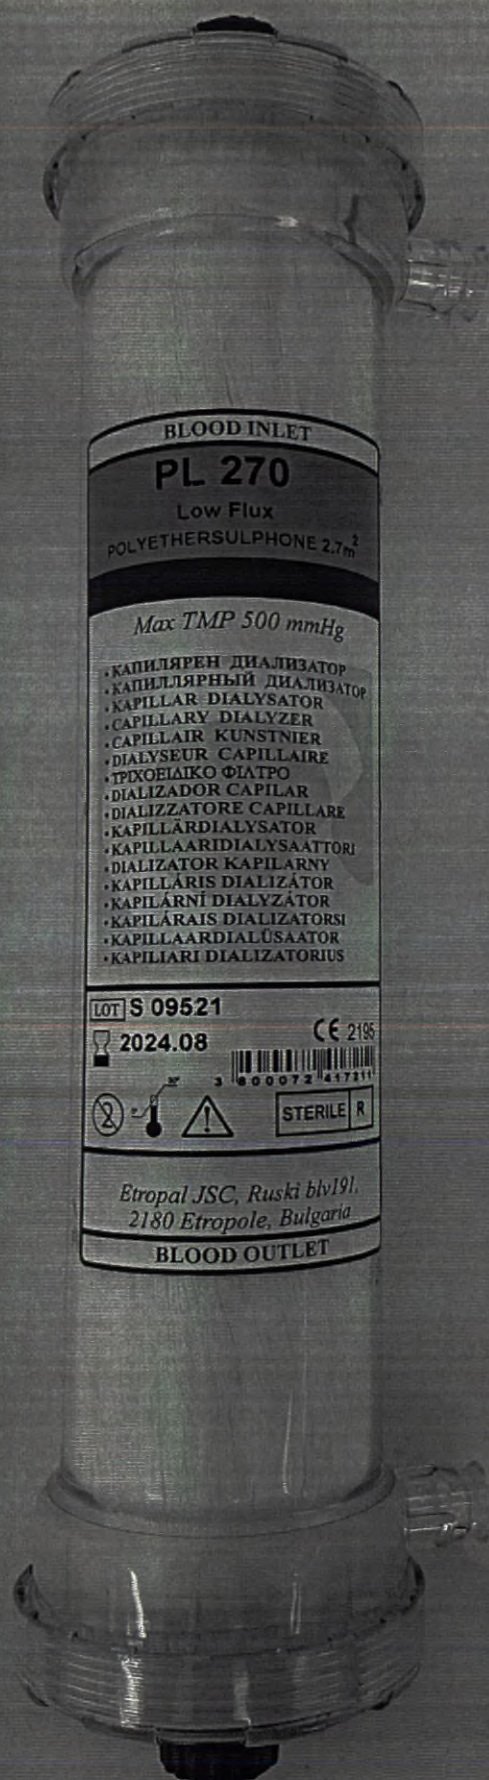

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэtersульфон с средней пропускной способностью (PM), модель: PM 100

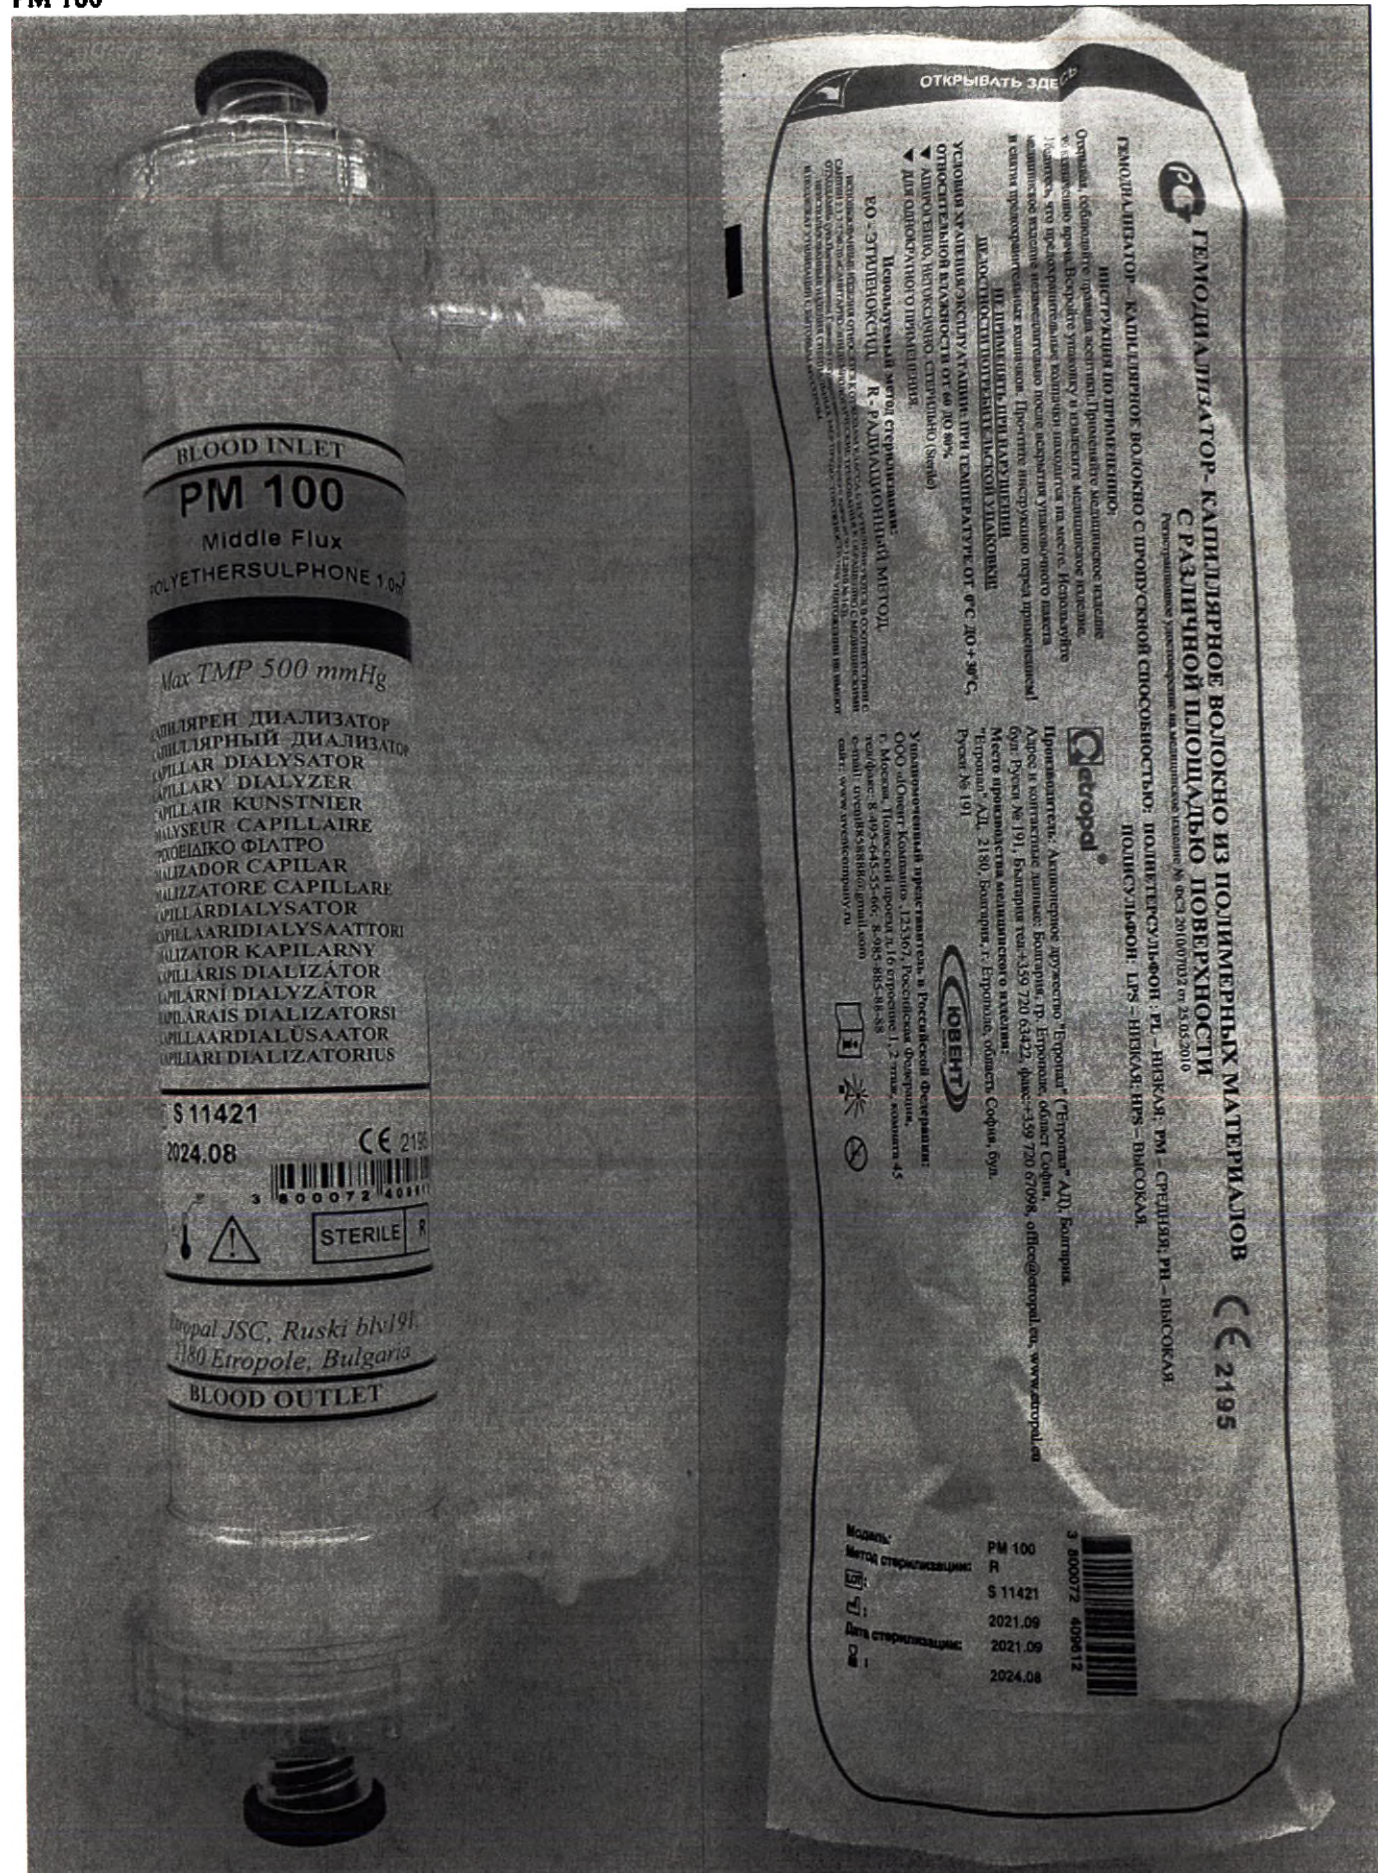

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полметерсульфон с средней пропускной способностью (PM), модель: PM 110




Гемодиализатор - капиллярное волокно Полниетерсульфон с средней пропускной способностью (PM), модель: PM 120



Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэтерсульфон с средней пропускной способностью (PM), модель: PM 130

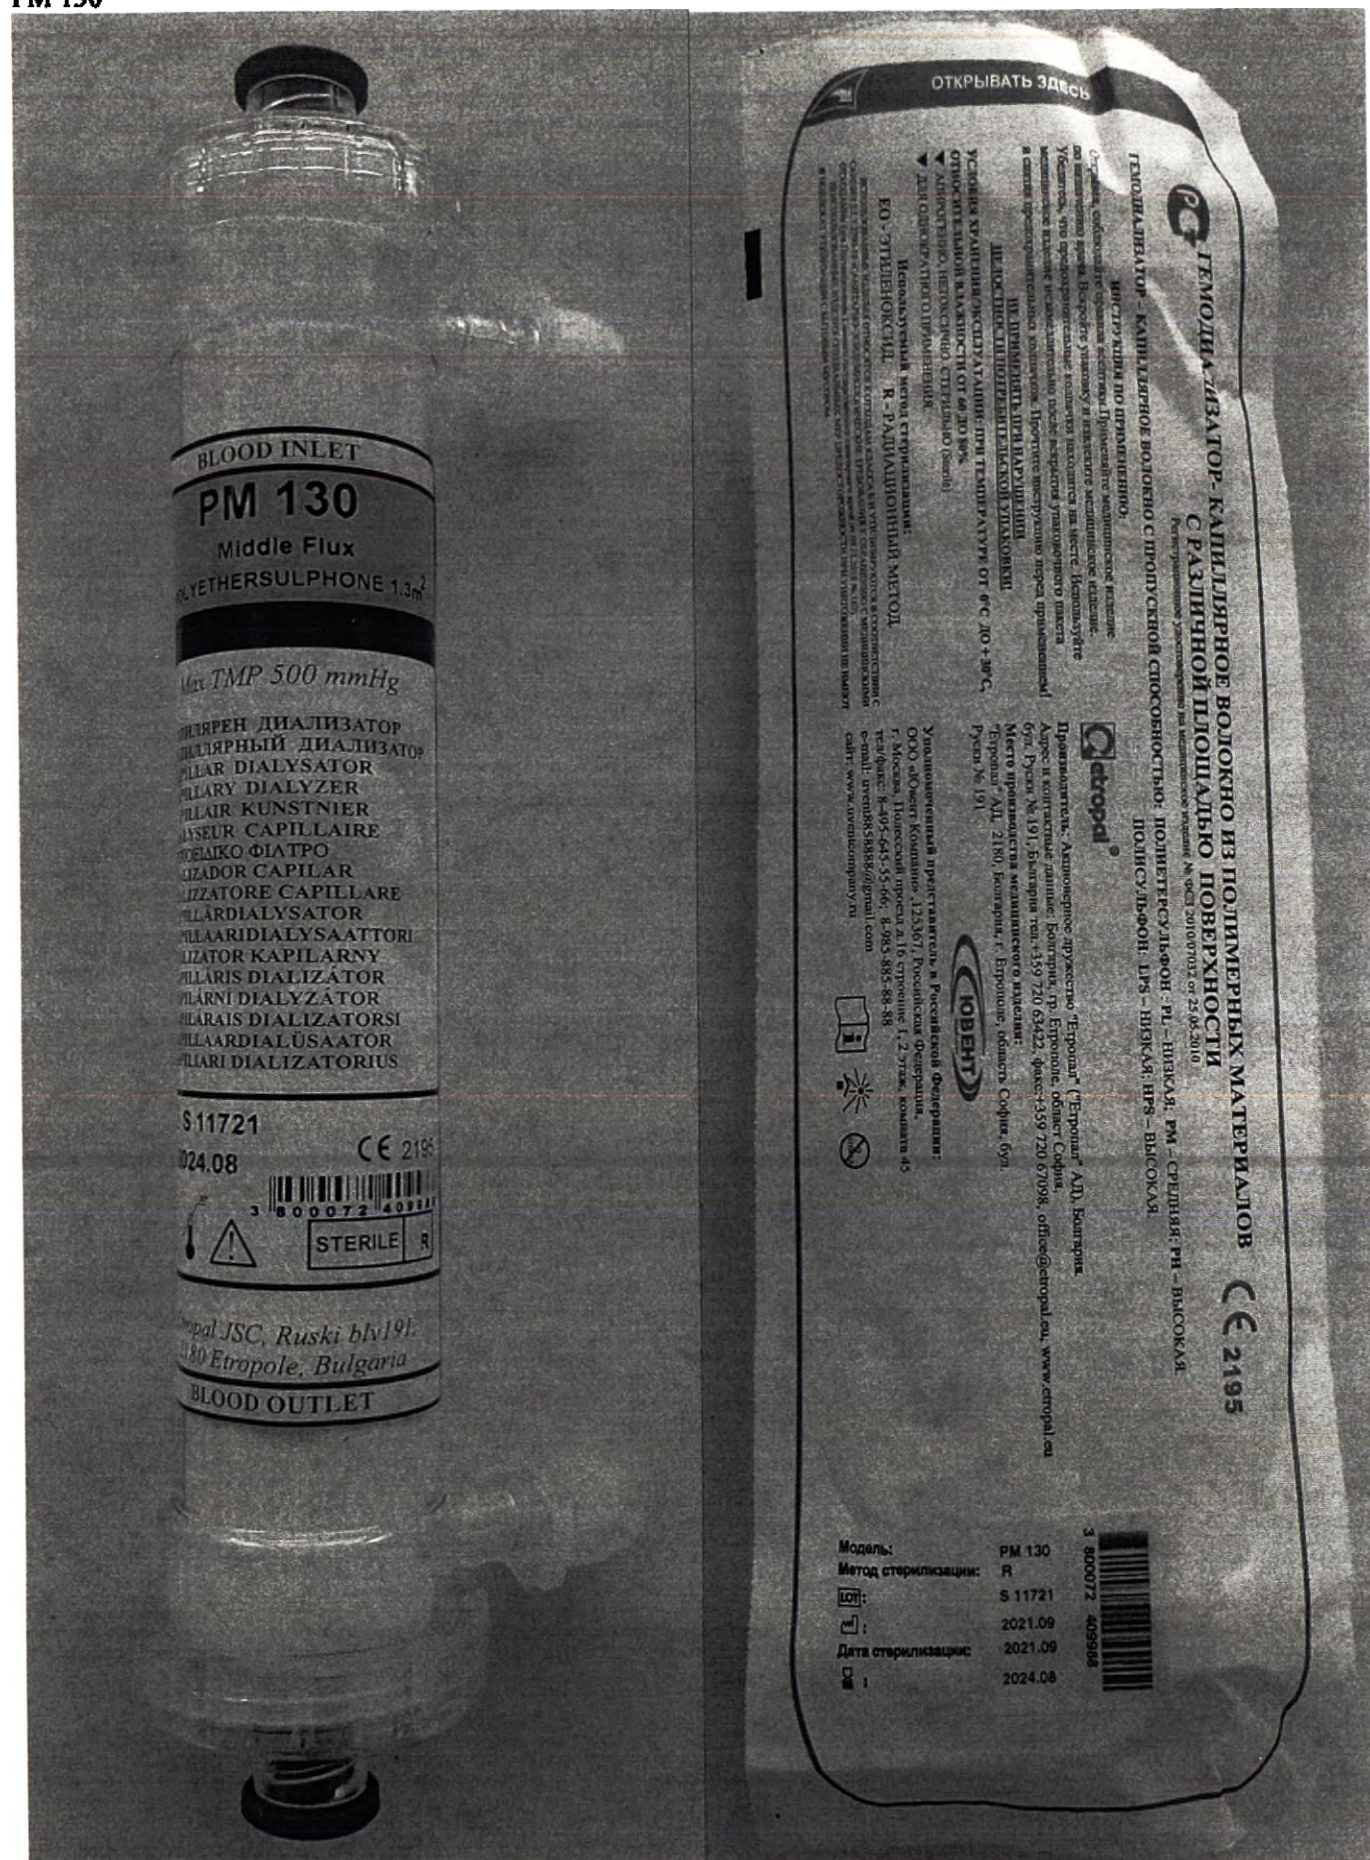

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

CE 2195

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности.

Модель: PM 130. Метод стерилизации: S 11721. Дата стерилизации: 2024.08.

Доставщик: Аэтоморное предприятие "Теропол" АД, Болгария.

Другие контактные данные: Болгария, г. Етрополе, район София, бул. Руски № 191. Болгария тел: +359 720 63422, факс: +359 720 67098, office@etropol.eu, www.etropol.eu

Место производства медицинского изделия: Теропол АД, 2190, Болгария, г. Етрополе, область София, бул. Руски № 191.

Уполномоченный представитель в Российской Федерации: ООО «Ювент Комадине», 125367, Российская Федерация, г. Москва, Покосский проезд д.16, стр.1, 2 этаж, комната 45

телефон: 8-495-645-55-66; 8-985-885-88-88
e-mail: ovent888888@gmail.com
сайт: www.juventcompany.ru


Модель: PM 130
Метод стерилизации: R
Идентификационный номер: S 11721
Дата стерилизации: 2021.09
2024.08

3 800072 409988

STERILE


Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэtersульфон с средней пропускной способностью (PM), модель: PM 140

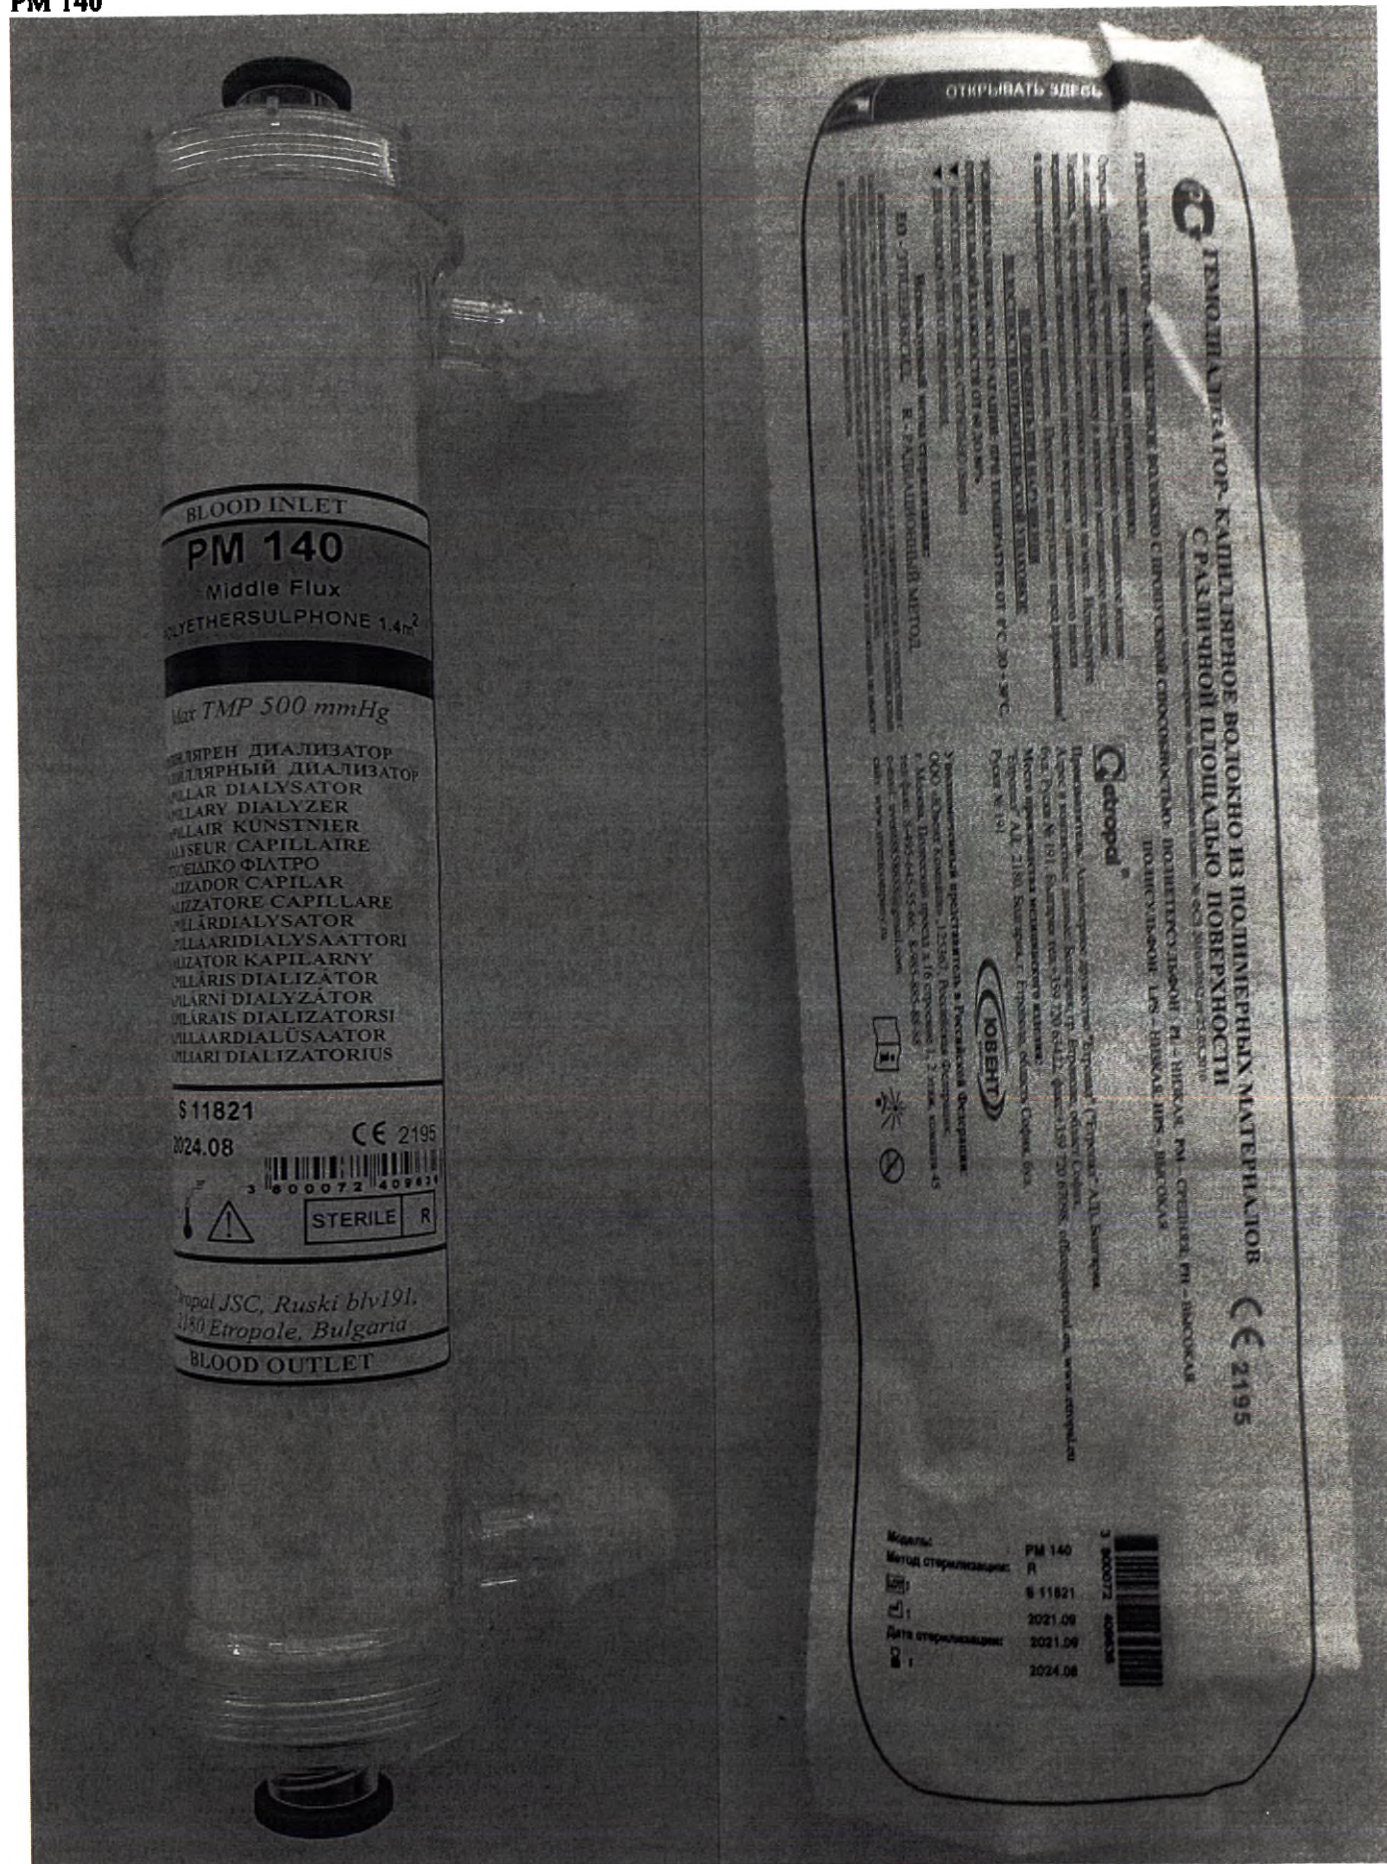


Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэтерсульфон с средней пропускной способностью (PM), модель: PM 160

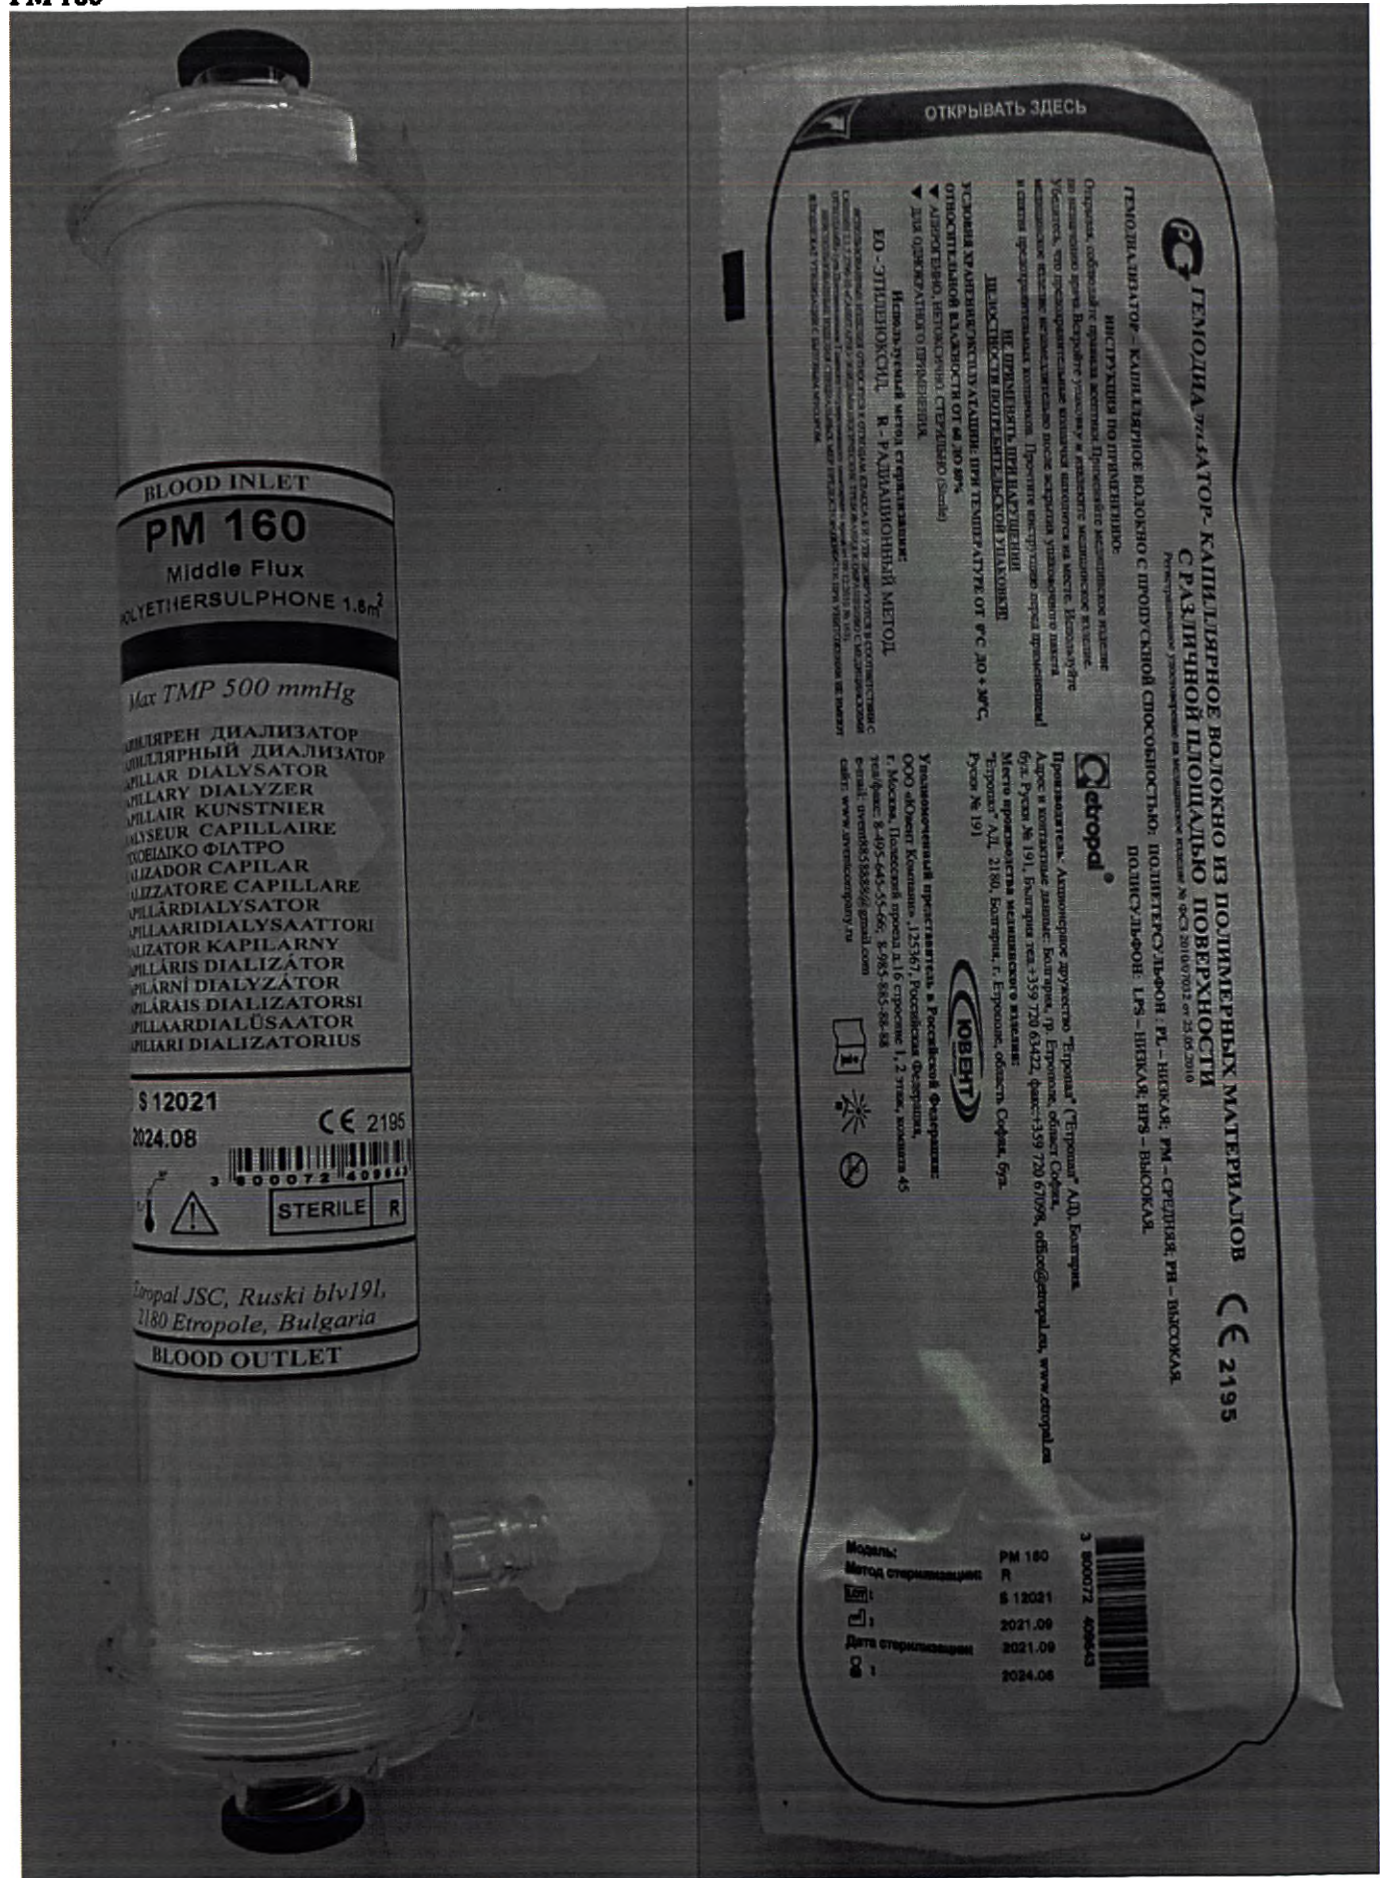

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсульфон с средней пропускной способностью (PM), модель: PM 170

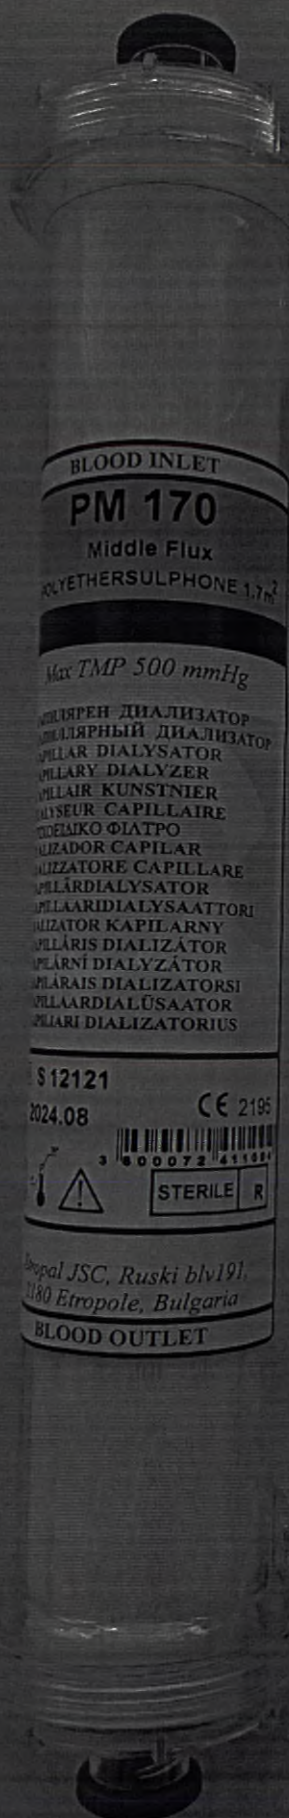

BLOOD INLET
PM 170
Middle Flux
POLYETHERSULPHONE 1.7m²
Max TMP 500 mmHg
КАПИЛЯРНЫЙ ДИАЛИЗАТОР
КАПИЛЯРНЫЙ ДИАЛИЗАТОР
CAPILLARY DIALYSATOR
CAPILLARY DIALYZER
CAPILLAIR KUNSTNIER
CAPILLAIRO FIATPO
KAPILAZADOR CAPILAR
KAPILIZZATORE CAPILLARE
KAPILLAARDIALYSAATTORI
KAPILAZATOR KAPILARNY
KAPILARIS DIALIZATOR
KAPILARNI DIALYZATOR
KAPILARIS DIALIZATORSI
KAPILLAARDIALUSAATOR
KAPILARI DIALIZATORIS
S 12121
2024.08
CE 2195
STERILE R
Bopal JSC, Ruski blv191,
2180 Etropole, Bulgaria
BLOOD OUTLET

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

CE 2195

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Очистка, обслуживание аппарата, контроль качества мембранного материала, контроль качества мембранного материала, контроль качества мембранного материала.

Условия хранения: в сухом, защищенном от влаги и пыли месте. Температура от +5 до +25 °C. Влажность не более 75%.

Использовать метод стерилизации: автоклавирование.

Условия хранения: в сухом, защищенном от влаги и пыли месте. Температура от +5 до +25 °C. Влажность не более 75%.

Условия хранения: в сухом, защищенном от влаги и пыли месте. Температура от +5 до +25 °C. Влажность не более 75%.

Условия хранения: в сухом, защищенном от влаги и пыли месте. Температура от +5 до +25 °C. Влажность не более 75%.

Условия хранения: в сухом, защищенном от влаги и пыли месте. Температура от +5 до +25 °C. Влажность не более 75%.

Условия хранения: в сухом, защищенном от влаги и пыли месте. Температура от +5 до +25 °C. Влажность не более 75%.

Умолчательный производитель в Республике Франция
ООО «Бопал» Контакт: 1234567, Республика Франция
г. Москва, Псковская область, Республика, г. Етropole, область София
694, Руски бл 191, Бопал тел: +359 720 63442, факс: +359 720 67098, office@bopal.eu, www.bopal.eu
e-mail: bopal@bopal.eu, bopal@bopal.eu
сайт: www.bopal.eu



Модель: PM 170
Метод стерилизации: R
S 12121
2021.08
2021.08
2024.08




Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэtersульфон с средней пропускной способностью (PM), модель: PM 180




Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэтерсульфон с средней пропускной способностью (PM), модель: PM 190

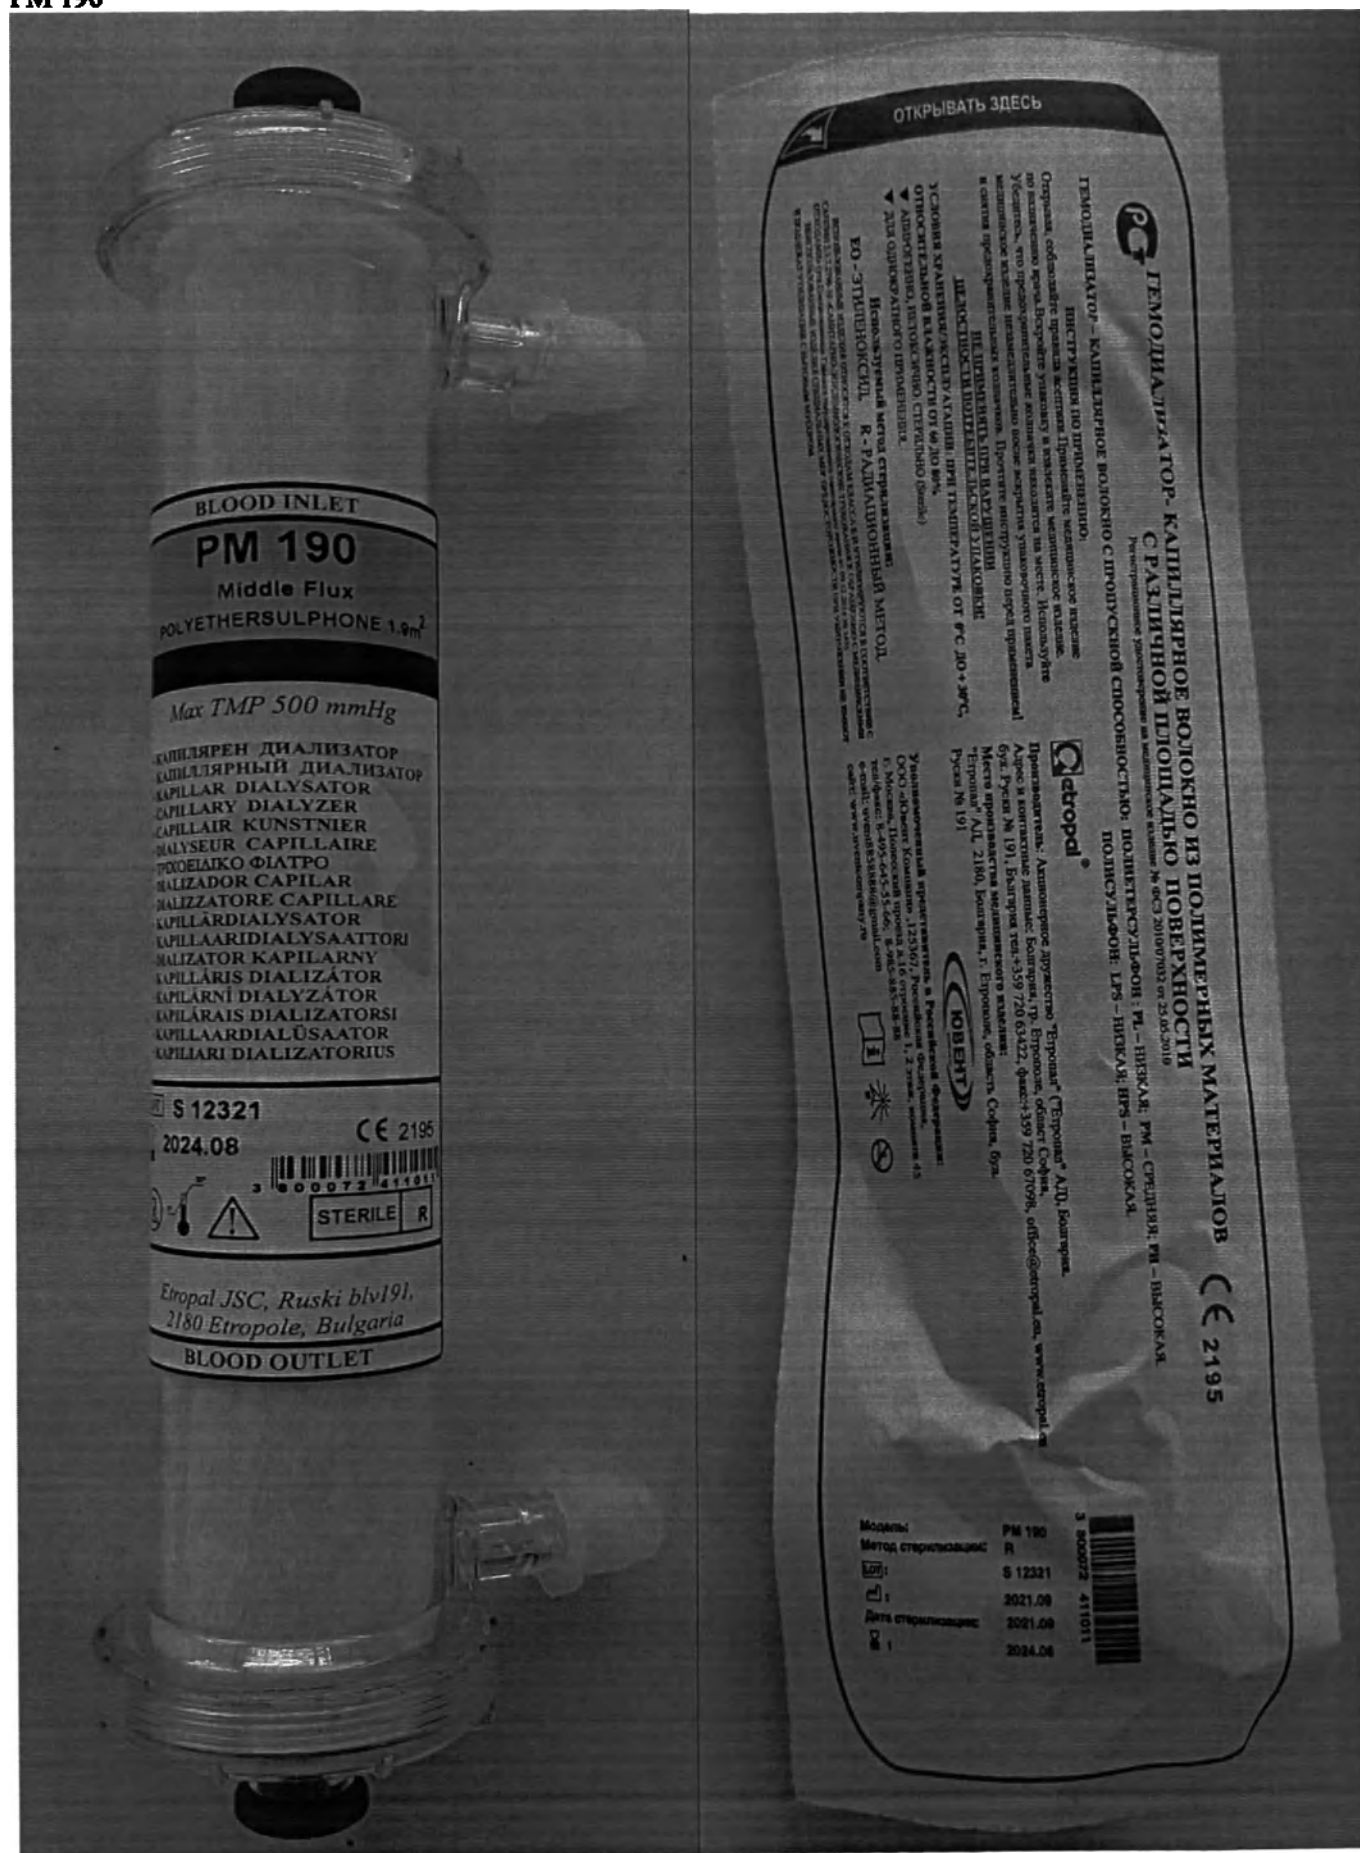

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэтерсульфон с средней пропускной способностью (PM), модель: PM 200

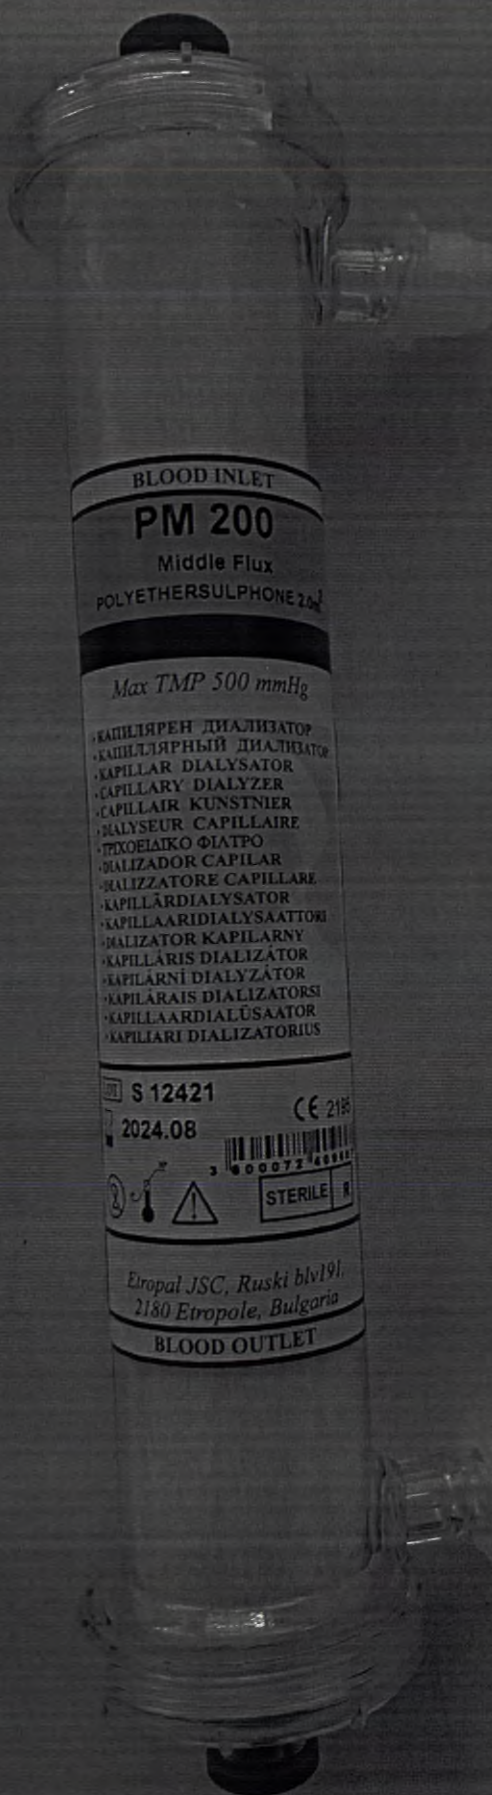


BLOOD INLET
PM 200
Middle Flux
POLYETHERSULPHONE 200

Max TMP 500 mmHg

КАПИЛЯРЕН ДИАЛИЗАТОР
КАПИЛЯРНЫЙ ДИАЛИЗАТОР
CAPILLAR DIALYSATOR
CAPILLARY DIALYZER
CAPILLAIR KUNSTNIER
DIALYSEUR CAPILLAIRE
ΠΡΟΧΕΙΛΑΚΟ ΦΙΑΤΡΟ
DIALIZADOR CAPILAR
DIALIZZATORE CAPILLARE
KAPILLÄRDIALYSATOR
KAPILLÄRIDIALYSAATTORI
DIALIZATOR KAPILARNY
KAPILLÄRIS DIALYZATOR
KAPILÄRNIS DIALYZATOR
KAPILÄRAIS DIALYZATORSI
KAPILLÄRDIALYSAATOR
KAPILIARI DIALIZATORIUS

S 12421

2024.08



STERILE

Etropal JSC, Ruski blv191,
2180 Etropole, Bulgaria

BLOOD OUTLET

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

CE 2195

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Открытая, свободная поверхность мембраны, применяемого мембранного материала по назначению. Вскрывайте упаковку и капиллярное мембранное изделие. Убедитесь, что предохранительные колпачки находятся на месте. Неправильное механическое воздействие на мембранное изделие может привести к повреждению и снижению пропускной способности. Проверьте инструкцию перед применением!


НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ ПОВЫШЕНИИ

УСЛОВИЙ УХРАНЕНИЯ/ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 6°C ДО +30°C, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ОТ 60 ДО 90%.

▲ ДИФФУЗИОННО-ПЕРОКСИДНО-СТЕРИЛИЗОВАНО (Spectra)

▲ ДЛЯ ОДИНОВРЕМЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Использование метода стерилизации: Р-РАДИКАЦИОННЫЙ МЕТОД. ФО-ЭТИЛЕНОВЫЙ. В-РАДИКАЦИОННЫЙ МЕТОД.




Полиэтерсульфон: РЛ - НИЗКАЯ, РМ - СРЕДНЯЯ, РН - ВЫСОКАЯ.

CE 2195

Производитель: Лабораторное предприятие "Европол" (Европол) АД, Болгария.
Адрес: 1910 Руски бл. 191, София, Р.Б. Еуропа, община София, бр.191, Руски бл.191, България тел: +359 720 63422, факс: +359 720 67098, office@etropal.eu, www.etropal.eu
Место производства мембранного изделия: Европол АД, 2180 Болгария, г. Етрополе, община София, бр.191, Руски бл.191



Уполномоченный представитель в Российской Федерации:
ООО "ЦИРМИ" Компания, 125367, Российская Федерация, г. Москва, Пискаревский пр-д, д.116, стропение 1, 2 этаж, комната 45
Телефон: 8-495-645-55-66; 8-905-885-88-88
e-mail: info@cirmi.ru, sales@cirmi.ru
сайт: www.dicirmir.ru




Модель: PM 200
Метод стерилизации: R
S 12421
2021.08
Дата стерилизации: 2021.08
2024.08




Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэтерсульфон с средней пропускной способностью (PM), модель: PM 210

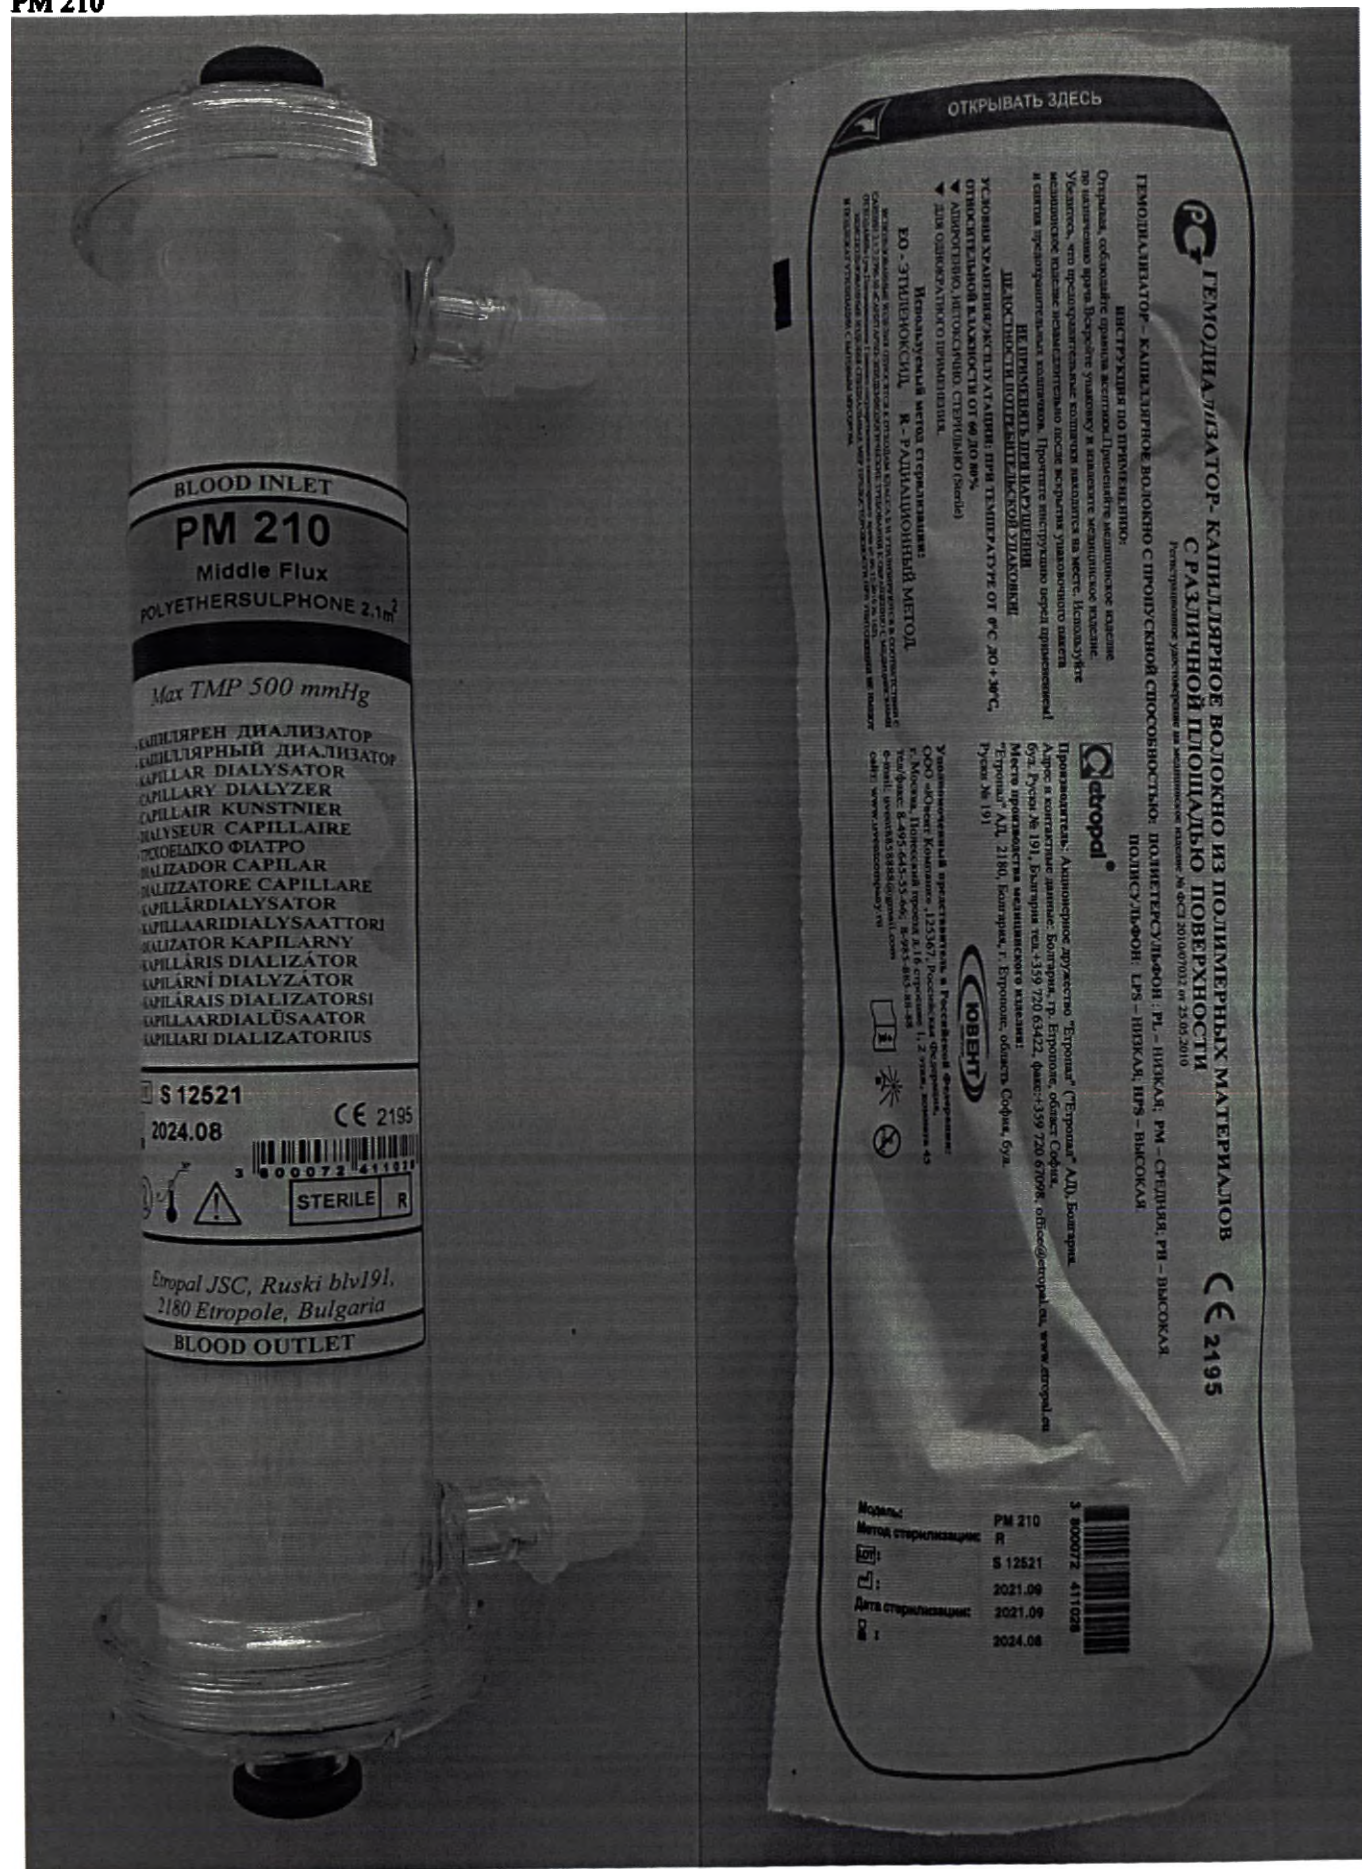

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэтерсульфон с средней пропускной способностью (PM), модель: PM 220

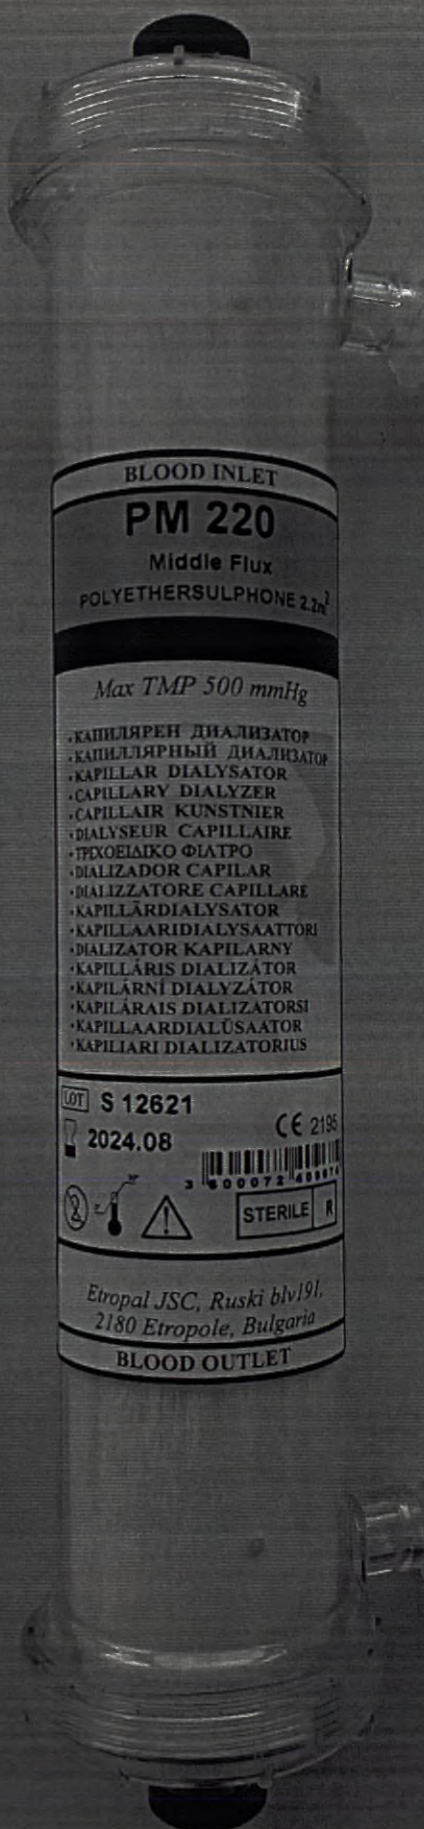

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

РЕГИСТРАЦИЯ удостоверения на медицинское изделие № ФСЗ 201.007032 от 23.05.2010

ПОЛИСУЛЬФОН: LPS - НИЗКАЯ, PPS - ВЫСОКАЯ

CE 2195

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Оригинал, содержащий правила эксплуатации, примените к медицинскому изделию по назначению. Вскрытие упаковки и применение медицинского изделия по назначению, что предусмотрено инструкцией, является частью ответственного подхода к безопасности пациента. Проверьте инструкцию перед применением изделия, чтобы убедиться, что изделие соответствует вашим требованиям.

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДПРАВКА ИЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОТВЕРЖЕНИЕ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: температура хранения от +2 до +25°C, относительной влажности от 60 до 80%.

▲ АЛЮМИНИЙ, НЕТОКСИЧНО, СТЕРИЛЬНО (ready to use)

▲ ДЛЯ ОДНОВРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

Использовать метод стерилизации: R - РАДИАЦИОННЫЙ МЕТОД

PO - СТИЛЕНКОСИД

Использовать для гемодиализа в соответствии с инструкцией к устройству. Хранить в стерильном состоянии. Не использовать изделие, если упаковка повреждена. Не использовать изделие, если срок годности истек. Не использовать изделие, если срок годности истек. Не использовать изделие, если срок годности истек.

Etropal JSC

Промышленные, Амбулаторное, дружество "Биропал" АД, Болгария

Адрес и контактные данные: Болгария, гр. Биропол, область София, бул. Руски № 191, Билдинг тел: +359 720 63422, факс: +359 720 67058, office@etropal.bg, www.etropal.bg

Место производства медицинского изделия: "Биропал" АД, 2180, Болгария, гр. Биропол, область София, бул. Руски № 191

Уполномоченный представитель в Российской Федерации: ООО «Континент Конинго», 125367, Российская Федерация, г. Москва, Провский проезд д.16 стропане 1, 2 этаж, координат 45 тел: факс: +409-645-55-66, +9-985-885-88-88 e-mail: kcontingent@yandex.ru сайт: www.kcontingent.ru

ЮВЕНТ

Модель: PM 220

Метод стерилизации: R


LOT: S 12621

Дата стерилизации: 2021.08

Дата: 2024.08

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсульфон с средней пропускной способностью (PM), модель: PM 230

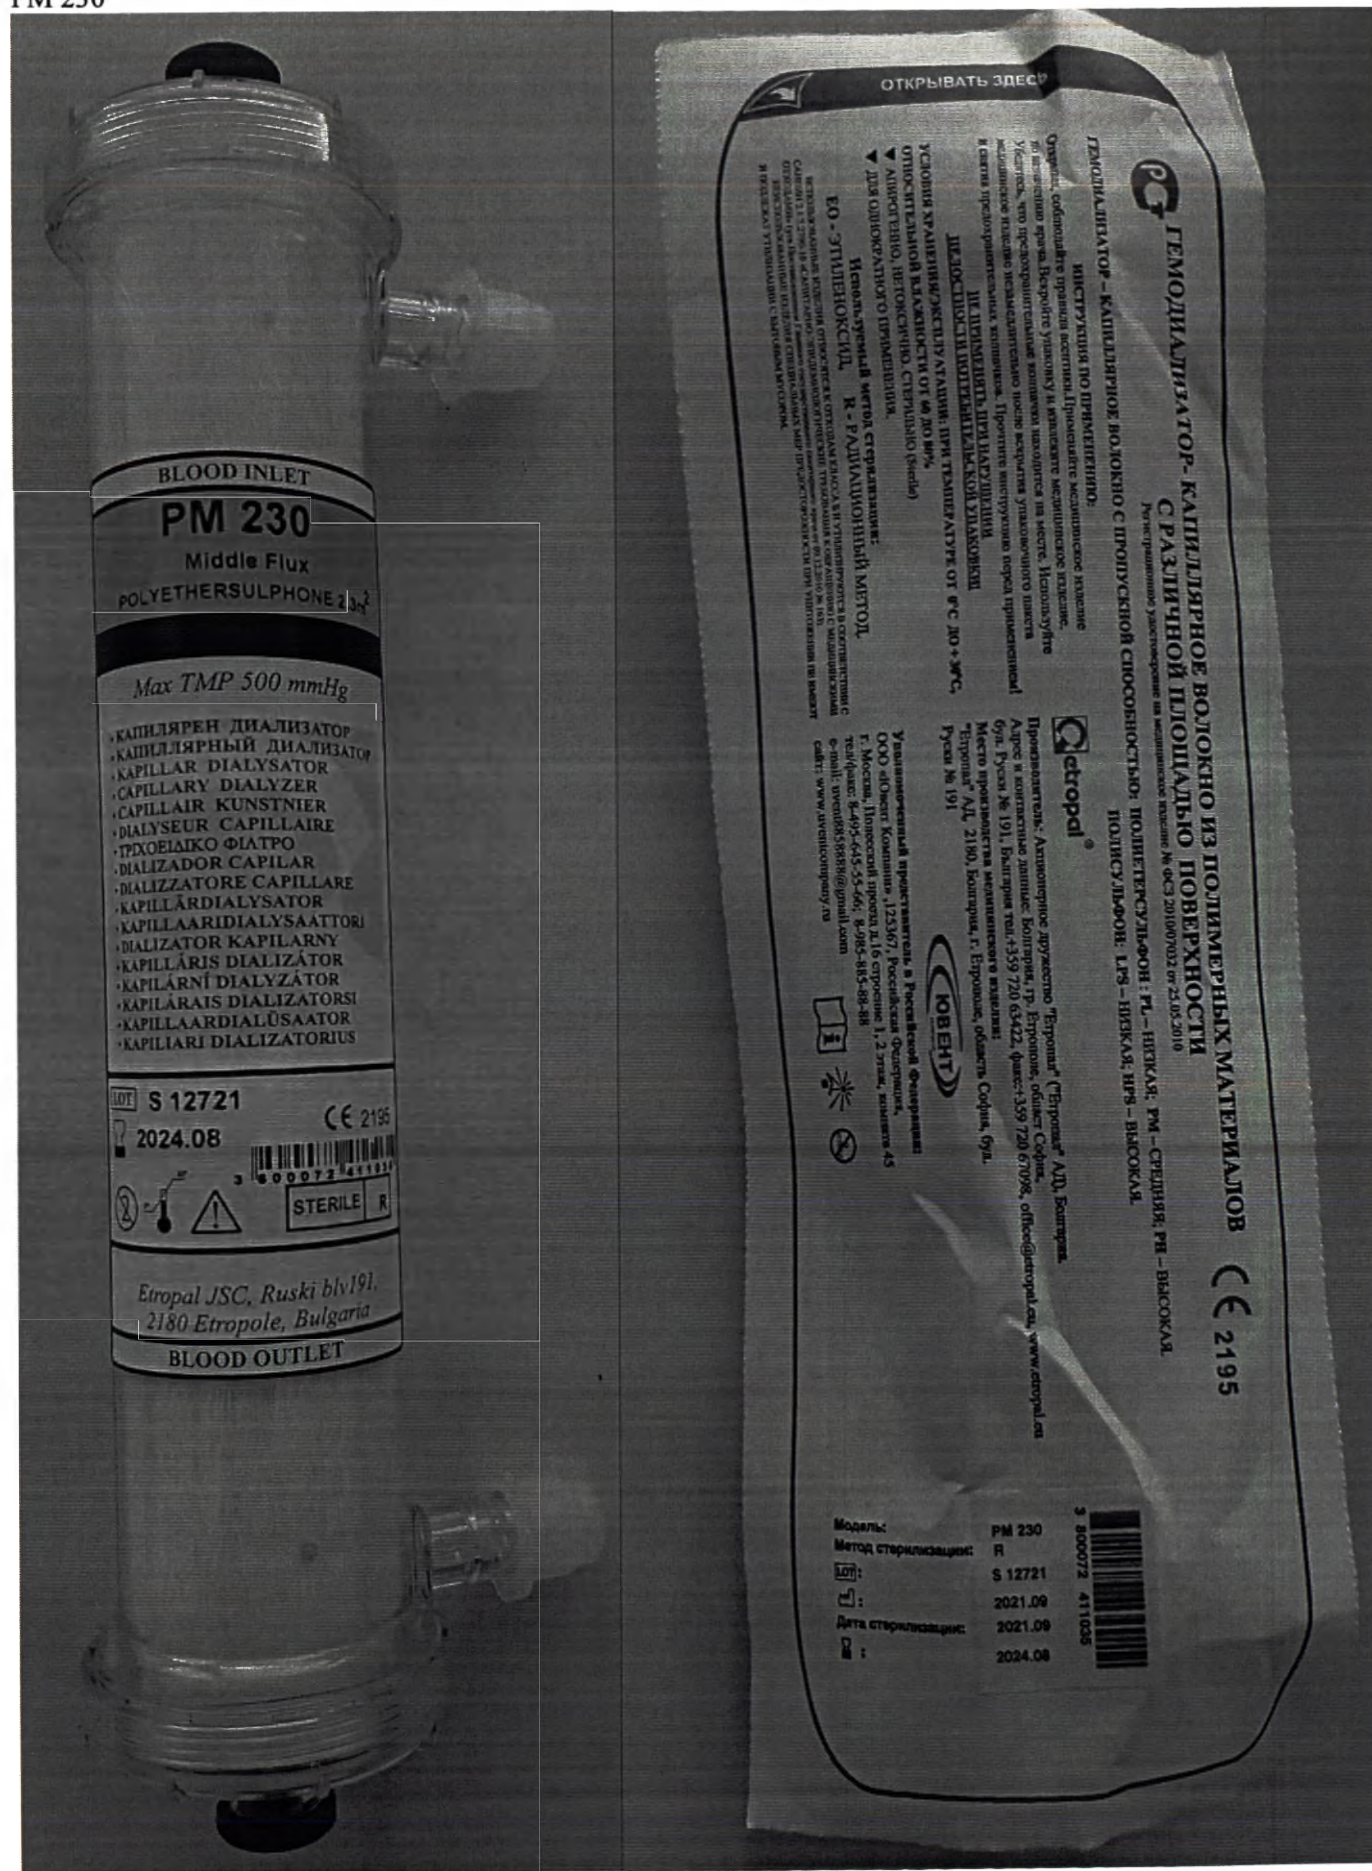

BLOOD INLET
PM 230
 Middle Flux
 POLYETHERSULPHONE
 Max TMP 500 mmHg
 • КАПИЛЛЯРЕН ДИАЛИЗАТОР
 • КАПИЛЛЯРНЫЙ ДИАЛИЗАТОР
 • KAPILLAR DIALYSATOR
 • CAPILLARY DIALYZER
 • CAPILLAIR KUNSTNIER
 • DIALYSEUR CAPILLAIRE
 • ΤΡΙΧΟΕΛΙΚΟ ΦΙΑΤΡΟ
 • DIALIZADOR CAPILAR
 • DIALIZZATORE CAPILLARE
 • KAPILLÄRDIALYSATOR
 • KAPILLÄRIDIALYSAATTORI
 • DIALIZATOR KAPILARNY
 • KAPILLÄRIS DIALIZÄTOR
 • KAPILÄRNI DIALYZÄTOR
 • KAPILÄRÄIS DIALIZÄTORSI
 • KAPILLÄRDIALÜSAATOR
 • KAPILIARI DIALIZATORIS
 S 12721
 2024.08
 STERILE R
 Etropal JSC, Ruski blv191,
 2180 Etropole, Bulgaria
 BLOOD OUTLET

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
 С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

Инструкция по применению:
 Очистите, соблюдайте правила асептики. Промойте мембранное изделие.
 По окончании промывки удалите из изделия все остатки моющего средства.
 Убедитесь, что перед применением изделие находится в стерильном состоянии.
 Изделие не подлежит повторному использованию.
 Не применять при нарушении целостности мембраны.
 Не использовать изделие при температуре от 0°C до +35°C.
 Условия хранения: влажность от 60 до 90%
 Срок годности: 24 месяца со дня изготовления.
 Для окончательного подтверждения качества изделия обратитесь к производителю.

ЕО - ЭТИЛЕНОКСИД К - РАДИКАЦИОННЫЙ МЕТОД
 Метод стерилизации: К - РАДИКАЦИОННЫЙ МЕТОД

Упаковочная единица: 1 шт. в стерильной упаковке.
 Адрес: 191000, г. Москва, ул. Басовская, д. 191, стр. 1.
 Контакт: 8-495-645-55-66, 8-495-645-55-67, 8-495-645-55-68
 e-mail: info@etropal.com, sales@etropal.com
 сайт: www.etropal.com

Упаковочная единица: 1 шт. в стерильной упаковке.
 Адрес: 191000, г. Москва, ул. Басовская, д. 191, стр. 1.
 Контакт: 8-495-645-55-66, 8-495-645-55-67, 8-495-645-55-68
 e-mail: info@etropal.com, sales@etropal.com
 сайт: www.etropal.com

ЮВЕНТ


Европол АД, 2180, Болгария, г. Европол, община София, ул. Руски блв 191

С 2195

Модель: PM 230
 Метод стерилизации: R
 Lot: S 12721
 Дата стерилизации: 2021.09
 2024.08

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсульфон с средней пропускной способностью (PM), модель: PM 240

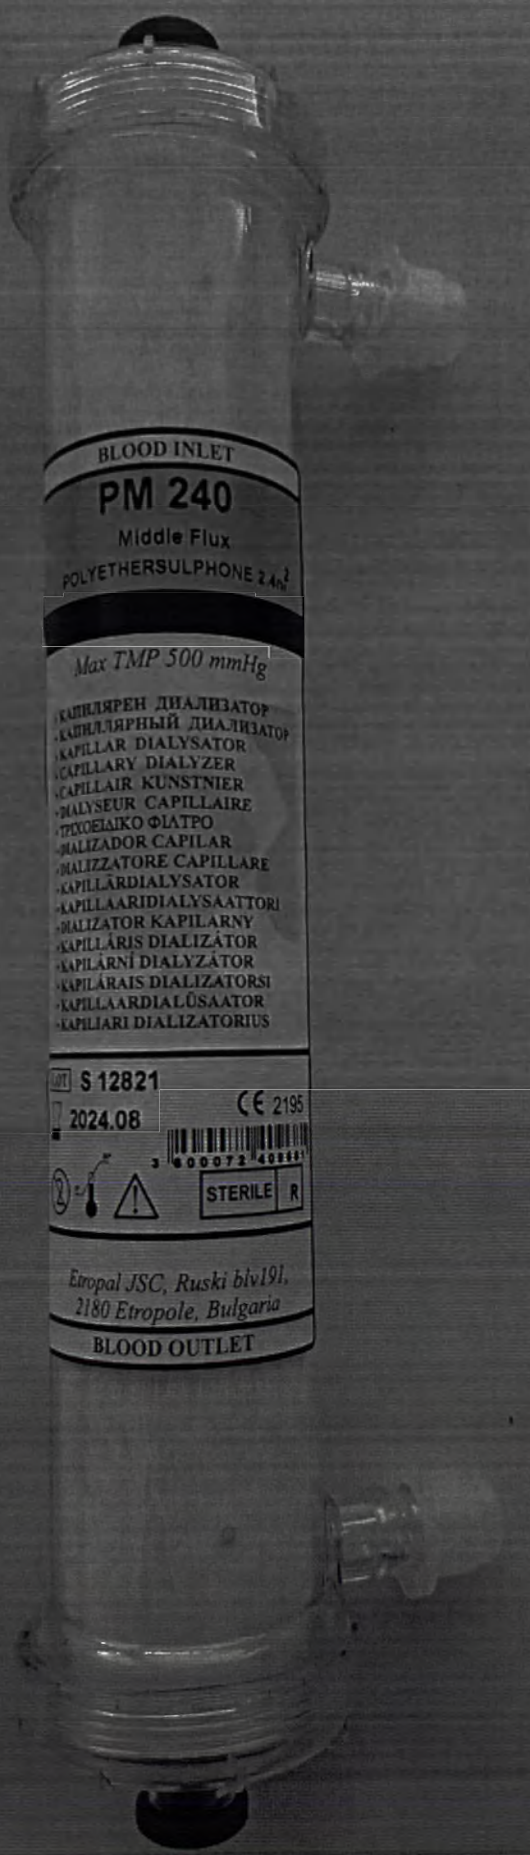

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

CE 2195

ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЛЯРНОЕ ВОЛОКНО С ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ: ПОЛИЭТЕРСУЛЬФОН. РЛ - НИЗКАЯ, РМ - СРЕДНЯЯ, РН - ВЫСОКАЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Открытая, обфлюидируемая трубка. Применяйте мембранное изделие по назначению в соответствии с инструкцией к изделию. Не используйте изделие, что просрочено или повреждено. Не используйте изделие, которое не соответствует после вскрытия упаковки. Не используйте изделие, которое не соответствует после вскрытия упаковки. Не используйте изделие, которое не соответствует после вскрытия упаковки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Жесткая упаковка, при температуре от 0°C до +30°C. Относительная влажность от 60 до 90%.

ДЛЯ ОДИНОВРЕМЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ:

Метод стерилизации: R - РАДИКАЦИОННЫЙ МЕТОД.

КО - ЭТИКЕТКА: R - РАДИКАЦИОННЫЙ МЕТОД.

Внимание! При использовании изделия необходимо соблюдать следующие правила: не использовать изделие, которое не соответствует после вскрытия упаковки. Не использовать изделие, которое не соответствует после вскрытия упаковки. Не использовать изделие, которое не соответствует после вскрытия упаковки.

Etropal JSC, Ruski blv 191, 2180 Etropole, Bulgaria

БЮЛЕТЕНЬ

Уполномоченный представитель в Российской Федерации: ООО «Юнеп Кооператив», 125367, Российская Федерация, г. Москва, Покосный проезд д.16/отделение 1, 2 этаж, комната 45. Контакт: 8-495-645-55-66, 8-495-645-88-88. e-mail: info@etropal.ru, etropal@etropal.ru, www.etropal.ru. Сайт: www.etropal.ru

Местное представительство мембранного изделия: «Европол» АД, 2180, Болгария, г. Етрополе, община София, бул. Руски № 191.

Модель: PM 240



Метод стерилизации: R

Lot: S 12821


Дата стерилизации: 2021.09

CE 2195

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэtersульфон с средней пропускной способностью (PM), модель: PM 250

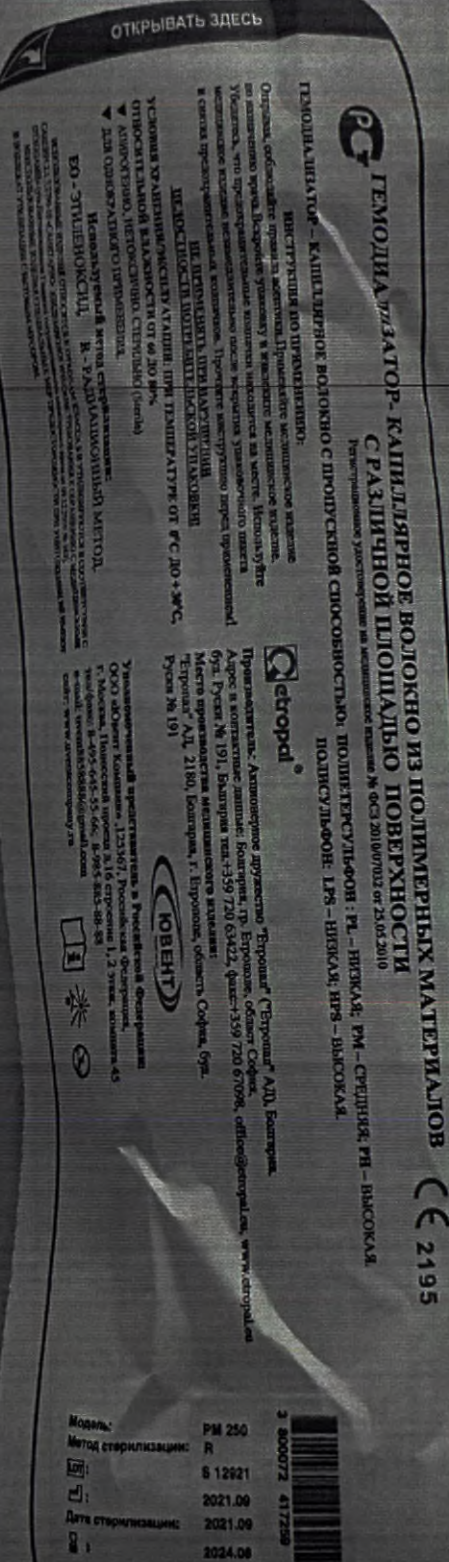
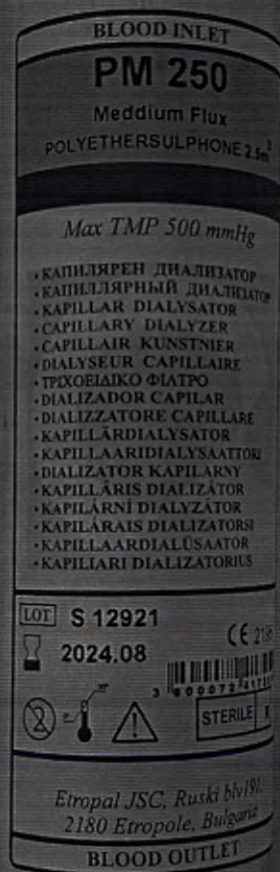


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полнтерсульфон с средней пропускной способностью (PM), модель: PM 260

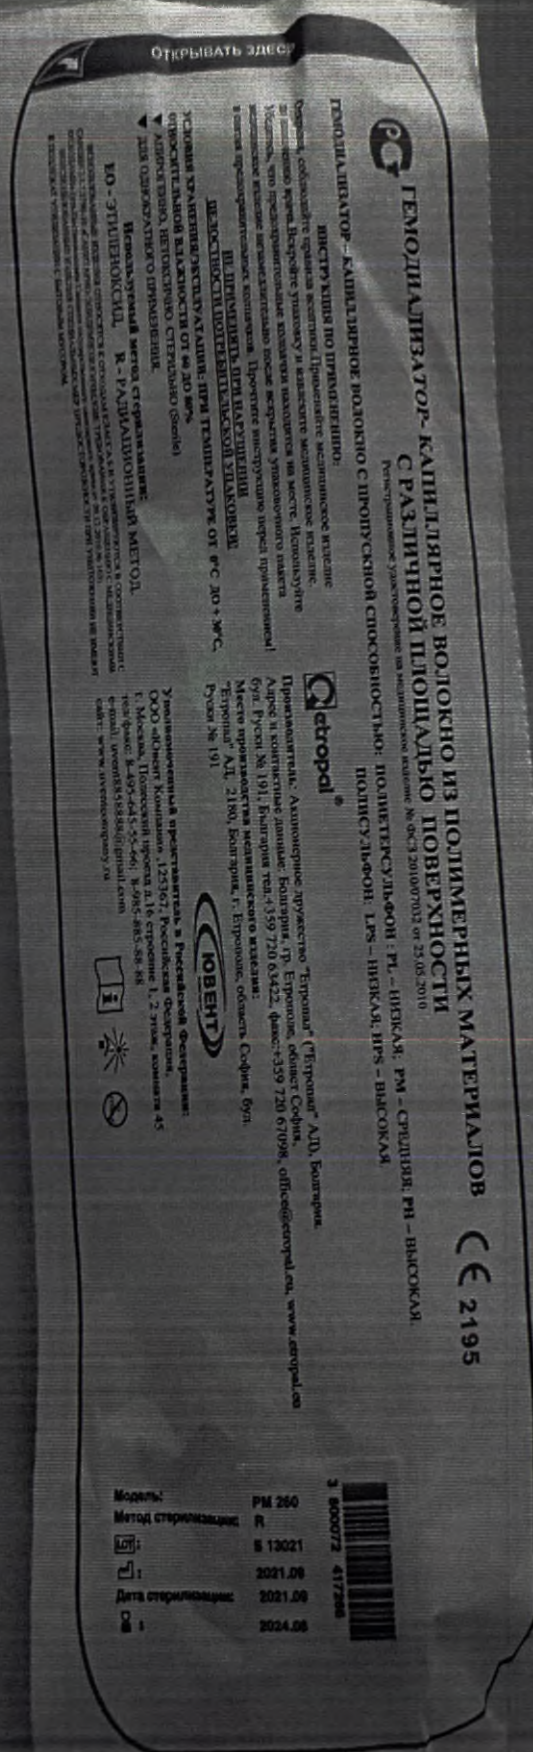


Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсульфон с средней пропускной способностью (PM), модель: PM 270

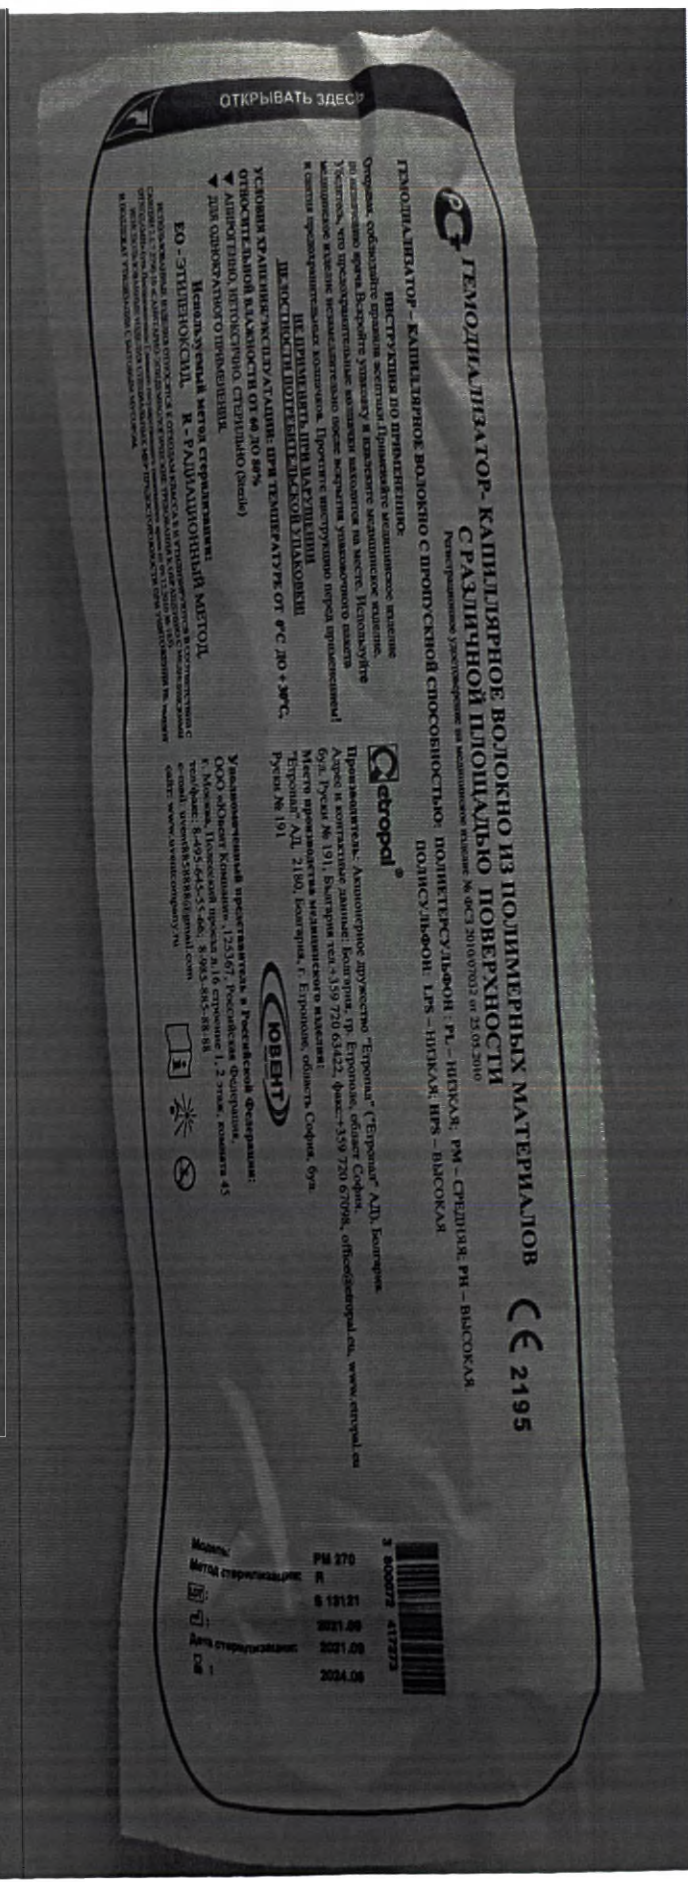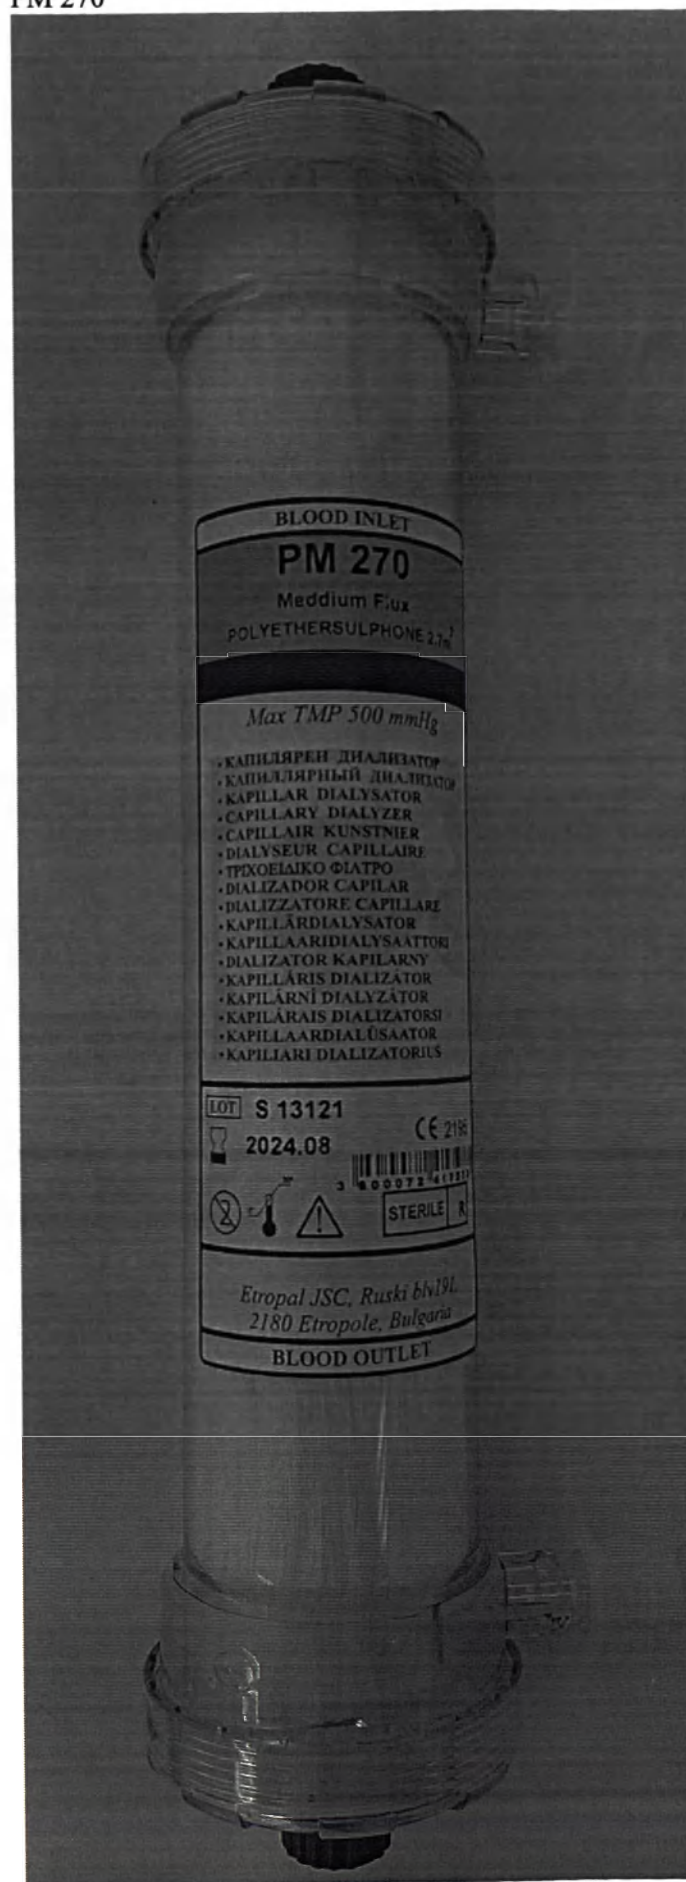


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсульфон с высокой пропускной способностью (РН), модель: РН 100

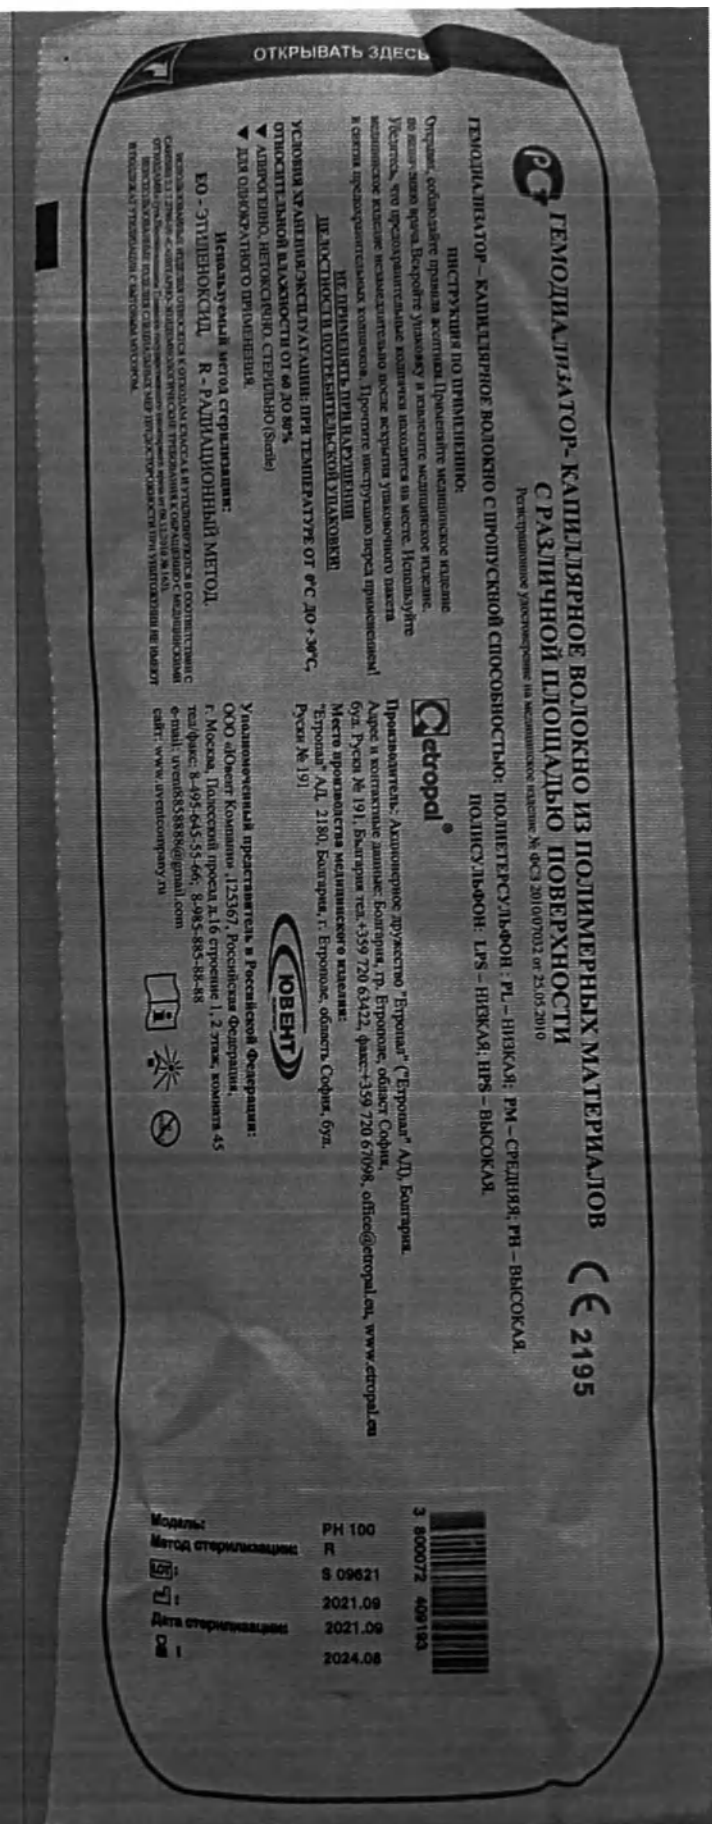

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэtersульфон с высокой пропускной способностью (PH), модель: PH 110

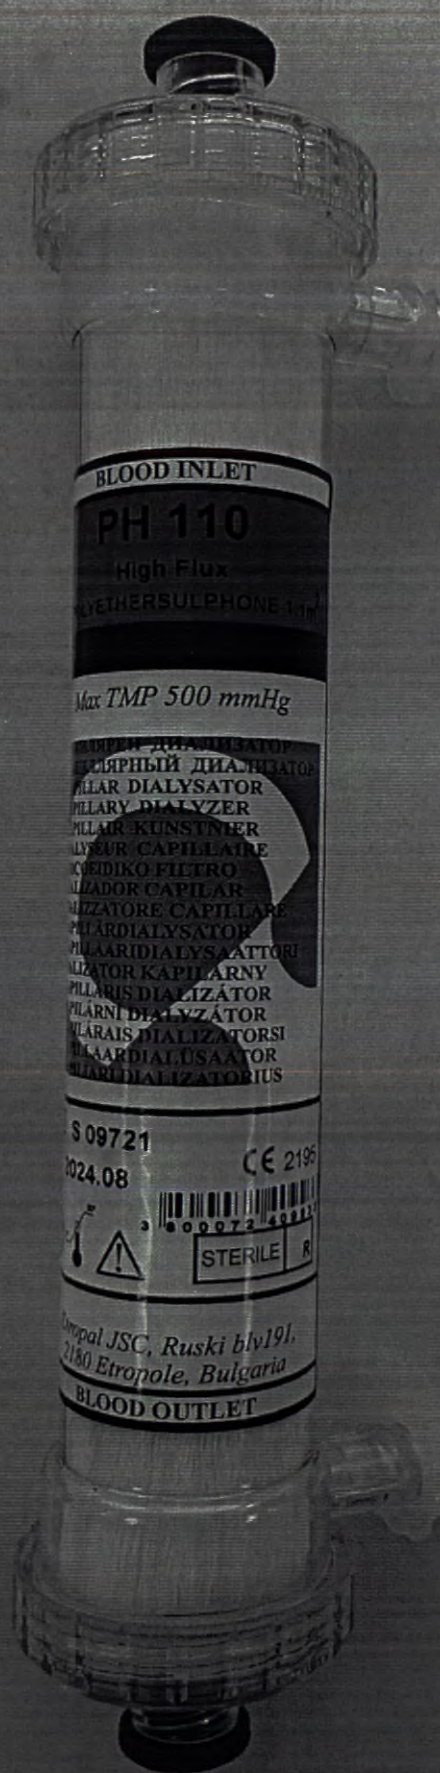

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

ГЕМОДИАЛИЗАТОР - КАПИЛЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСЗ 20100703 от 25.05.2010

ПОЛИЭТЕРСУЛЬФОН: РЛ - НИЗКАЯ; РМ - СРЕДНЯЯ; РН - ВЫСОКАЯ

ПОЛИСУЛЬФОН: ЛРС - НИЗКАЯ; НРС - ВЫСОКАЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Описание: оборудование для гемодиализа. Применяется медицинское изделие, изготовленное из полимера. Внутренняя поверхность изделия имеет высокую пропускную способность. Удостоверяется, что при использовании изделия не происходит утечки крови из пакета. Изделие не требует предварительной подготовки. Прочтите инструкцию перед применением и следуйте рекомендациям производителя.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ НАРУШЕНИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

Условия хранения/использования: при температуре от 0°C до +30°C.

Оптимальная влажность: от 60 до 80%.

Абсолютно герметично, стерильно (бюнд).

Для однократного применения.

Известные методы стерилизации:

ГО - ЭТЮВЕНКОСКИ, Р - РАДИАЦИОННЫЙ МЕТОД.

Сведения об изделии: изделие из полимера, изготовленное из полимера, которое не содержит никаких химических веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Изделие не содержит никаких химических веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Изделие не содержит никаких химических веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Atropal

Производитель: Акционерное общество "Европол" (Европол) АД, Болгария.
Адрес и контактные данные: Болгария, гр. Етрополе, община София, гр. Руски блв 191, България тел.: +359 720 63422, факс: +359 720 67098, office@atropal.eu, www.atropal.eu

Место производства медицинского изделия:
Европол АД, 2180, Болгария, гр. Етрополе, община София, България тел.: +359 720 63422

Уполномоченный представитель в Российской Федерации:
ООО «Европол», Коммуна, 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ярославская, д. 16, стр. 1, 2 этаж, контактный телефон: +7 495 645 55 66; E-mail: info@europharm.ru, www.europharm.ru

ЮВЕНТ

С 09721

2024.08

CE 2195

STERILE

Atropal JSC, Ruski blv191, 2180 Etropole, Bulgaria

BLOOD OUTLET

Модель: PH 110

Метод стерилизации: R

№: S 09721


Дата стерилизации: 2021.08

2021.08


2024.08

7 800072 400933

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэtersульфон с высокой пропускной способностью (PH), модель: PH 120

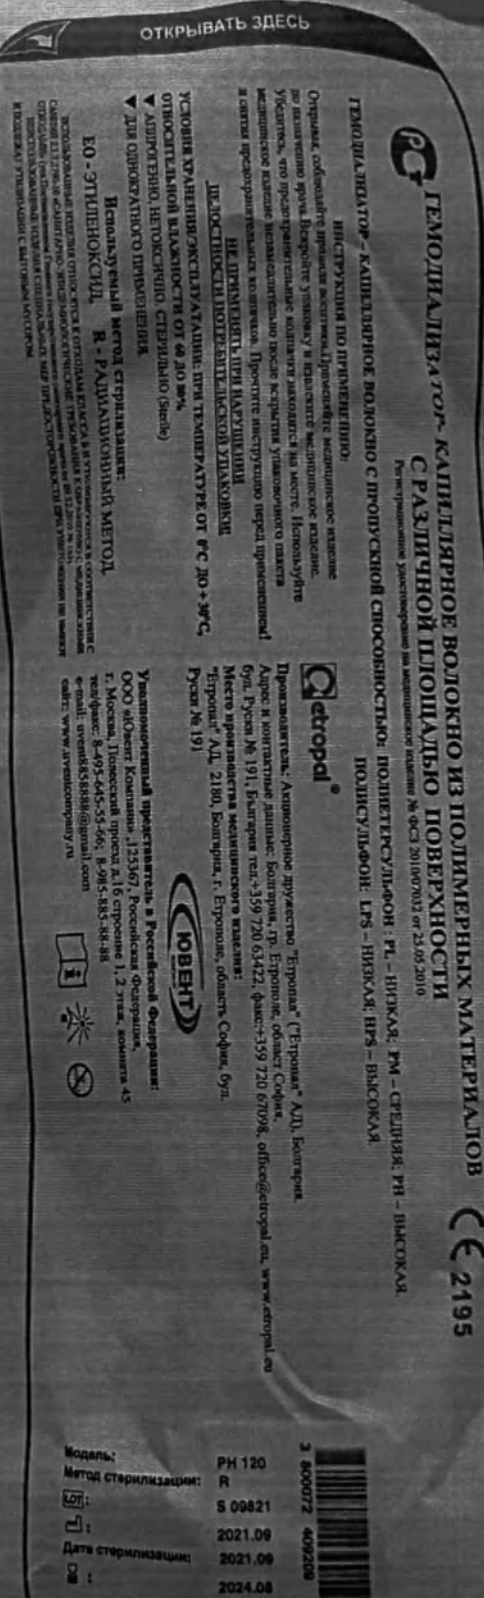


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэtersульфон с высокой пропускной способностью (PH), модель: PH 130

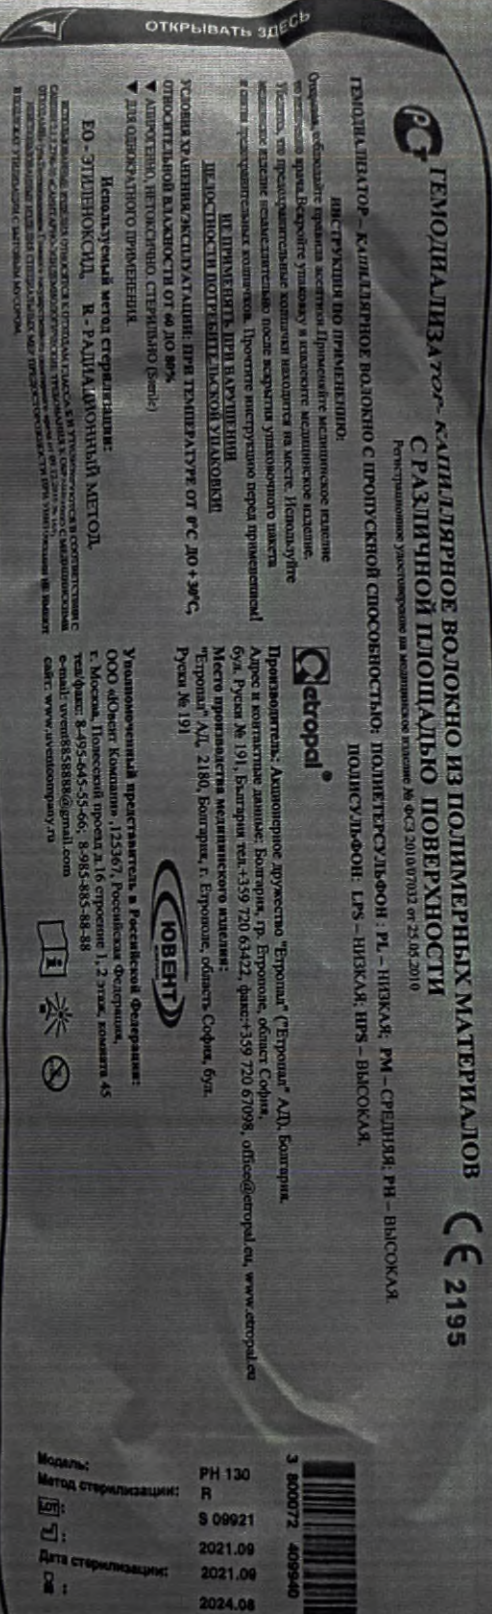


Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэтерсульфон с высокой пропускной способностью (PH), модель: PH 140

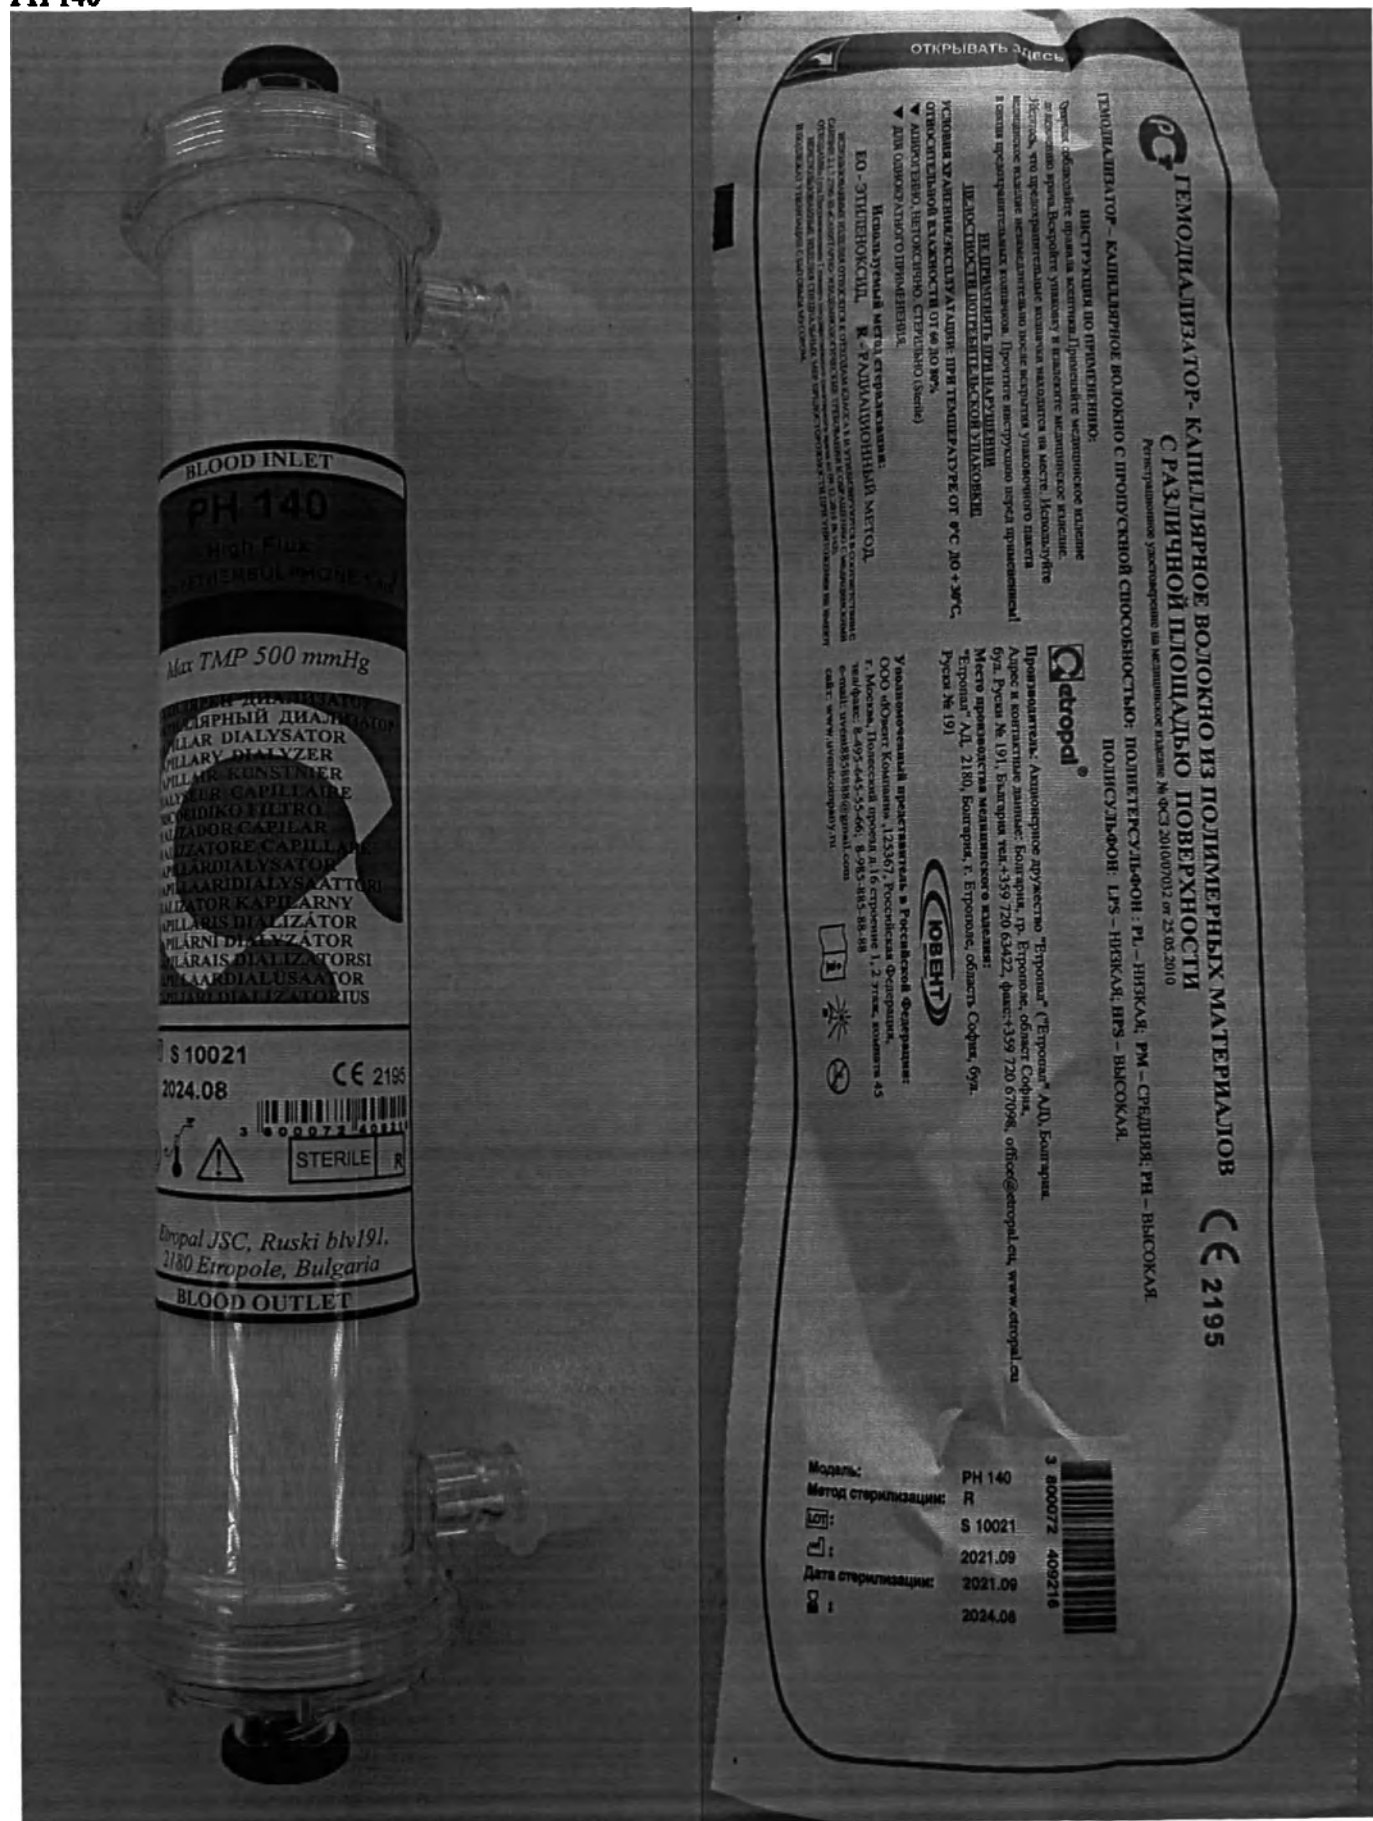


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэtersульфон с высокой пропускной способностью (PH), модель: PH 150

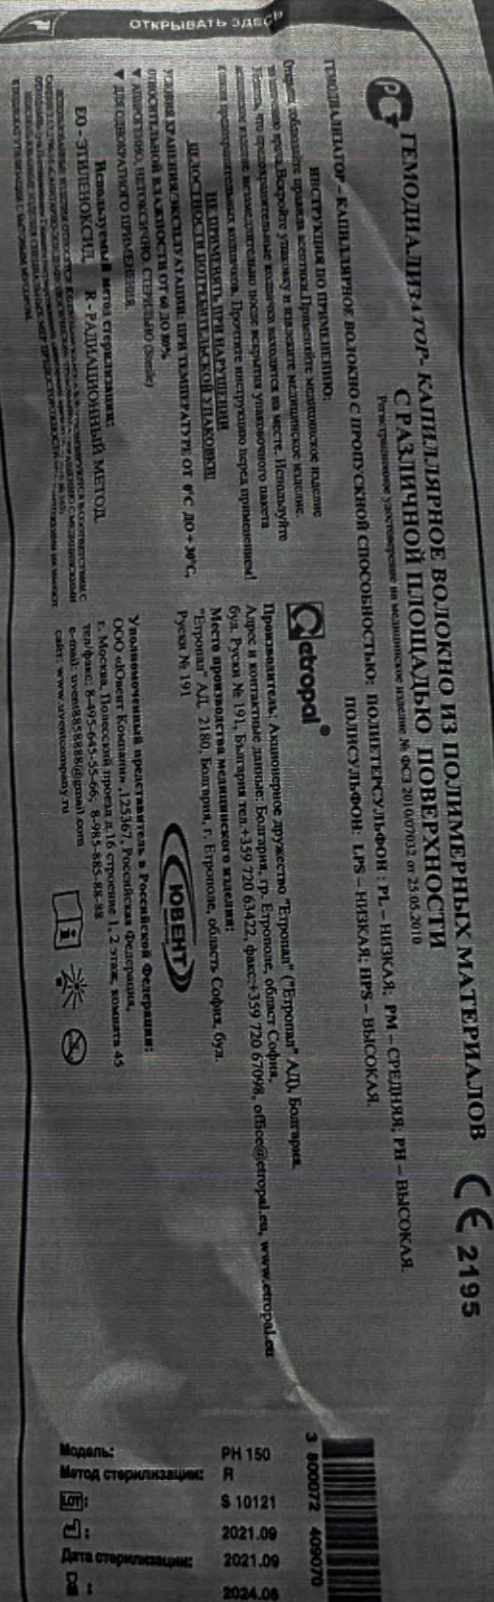

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсульфон с высокой пропускной способностью (PH), модель: PH 160

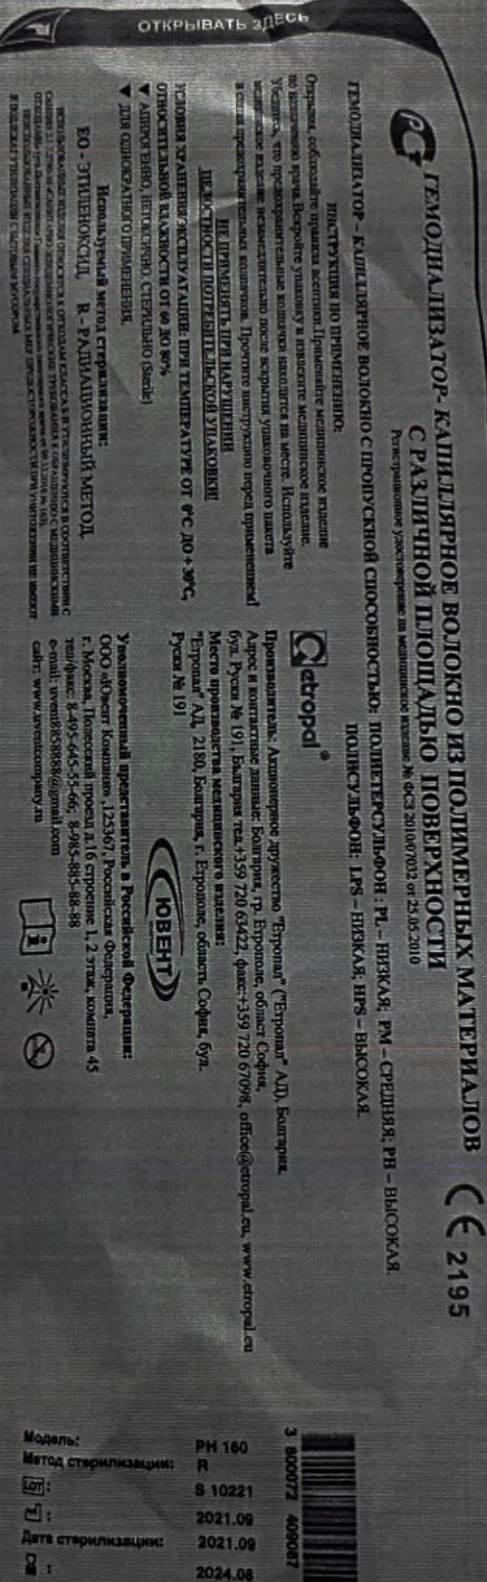

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэtersульфон с высокой пропускной способностью (PH), модель: PH 170

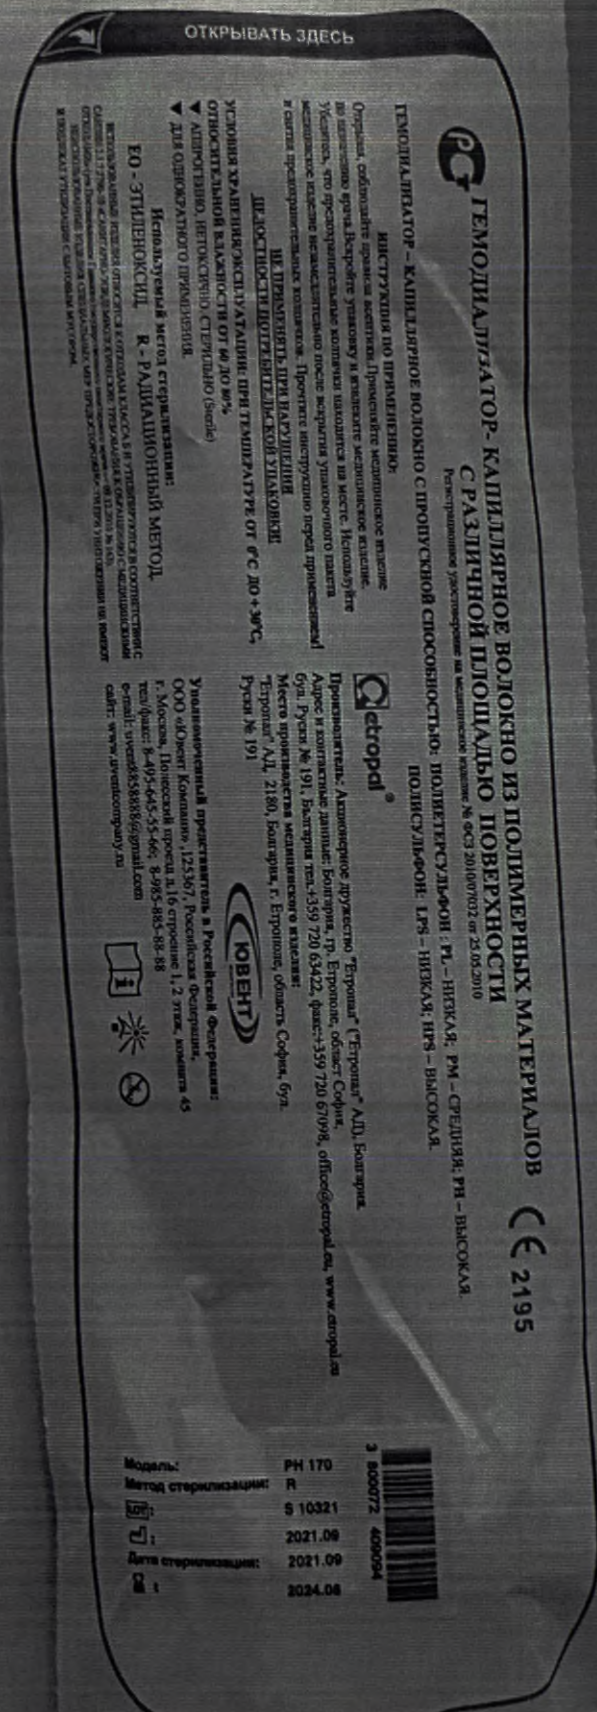


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэтерсульфон с высокой пропускной способностью (PH), модель: PH 180

[illegible]

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полнимерсульфон с высокой пропускной способностью (РН), модель: РН 190




Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиметерсульфон с высокой пропускной способностью (PH), модель: PH 200

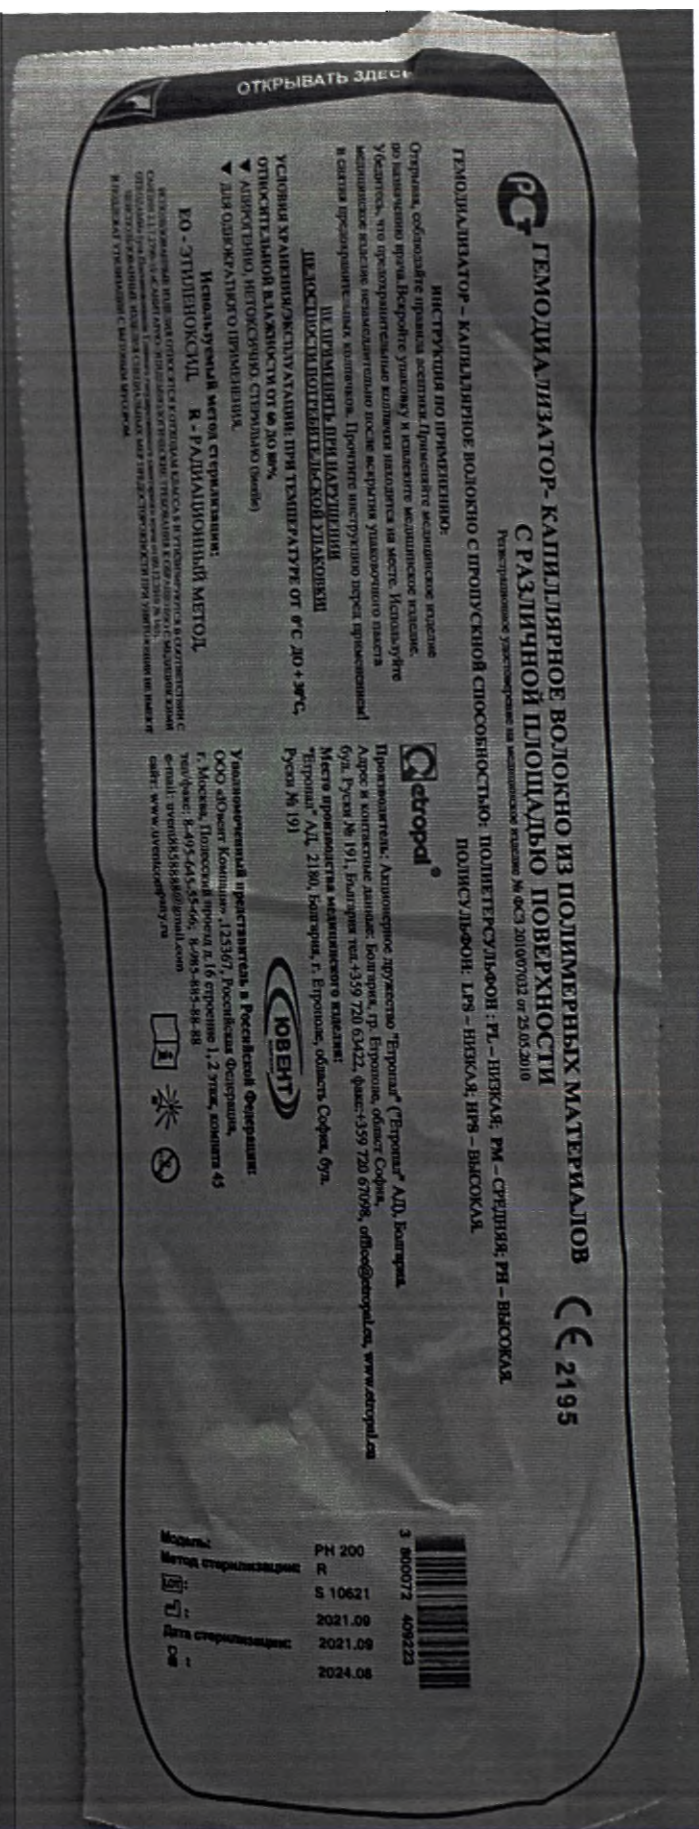


Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэтерсульфон с высокой пропускной способностью (PH), модель: PH 210

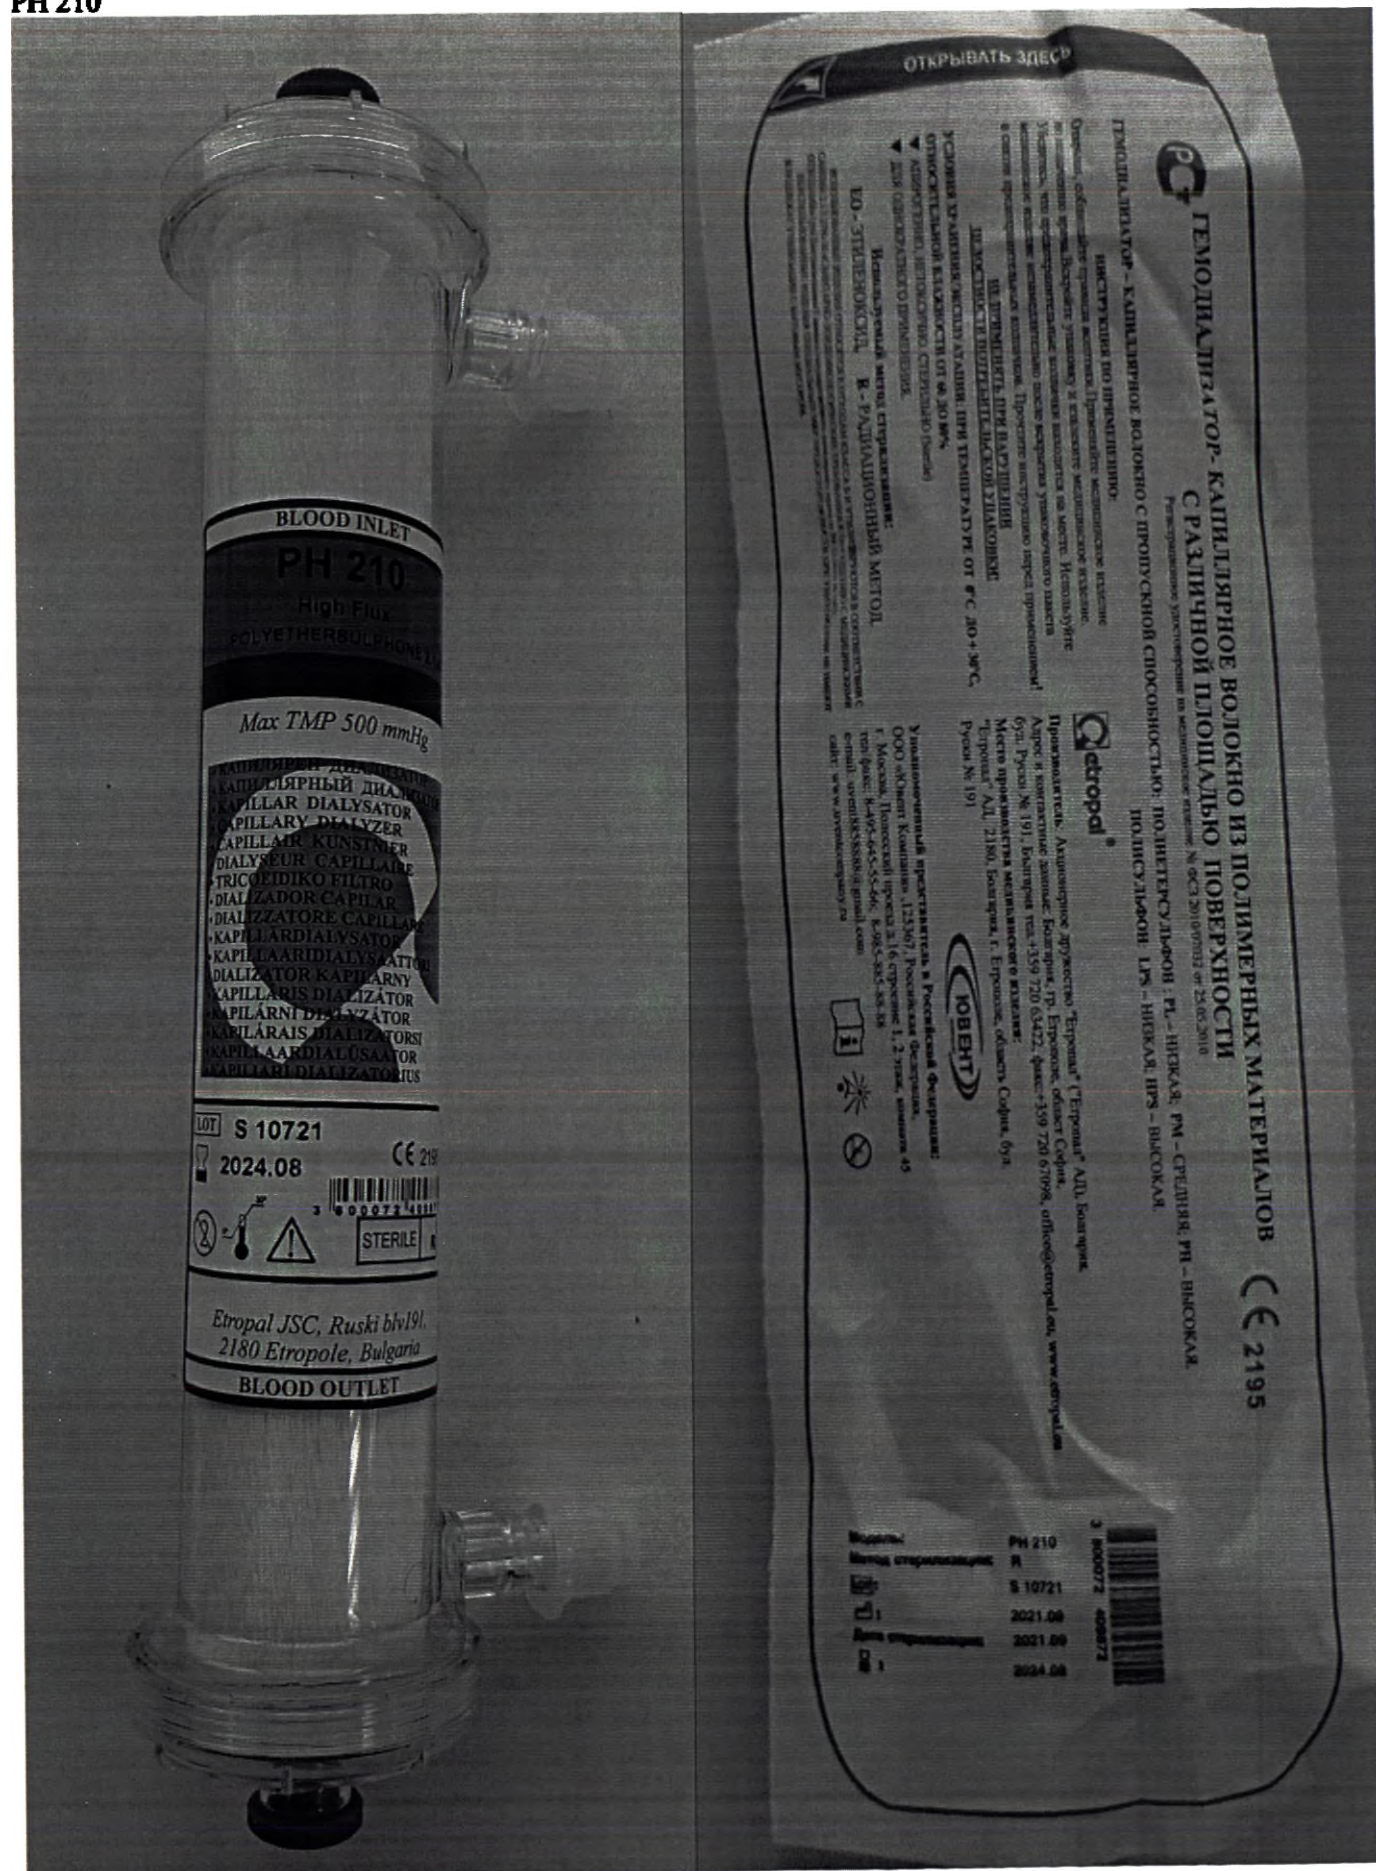


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэтерсульфон с высокой пропускной способностью (РН), модель: РН 220

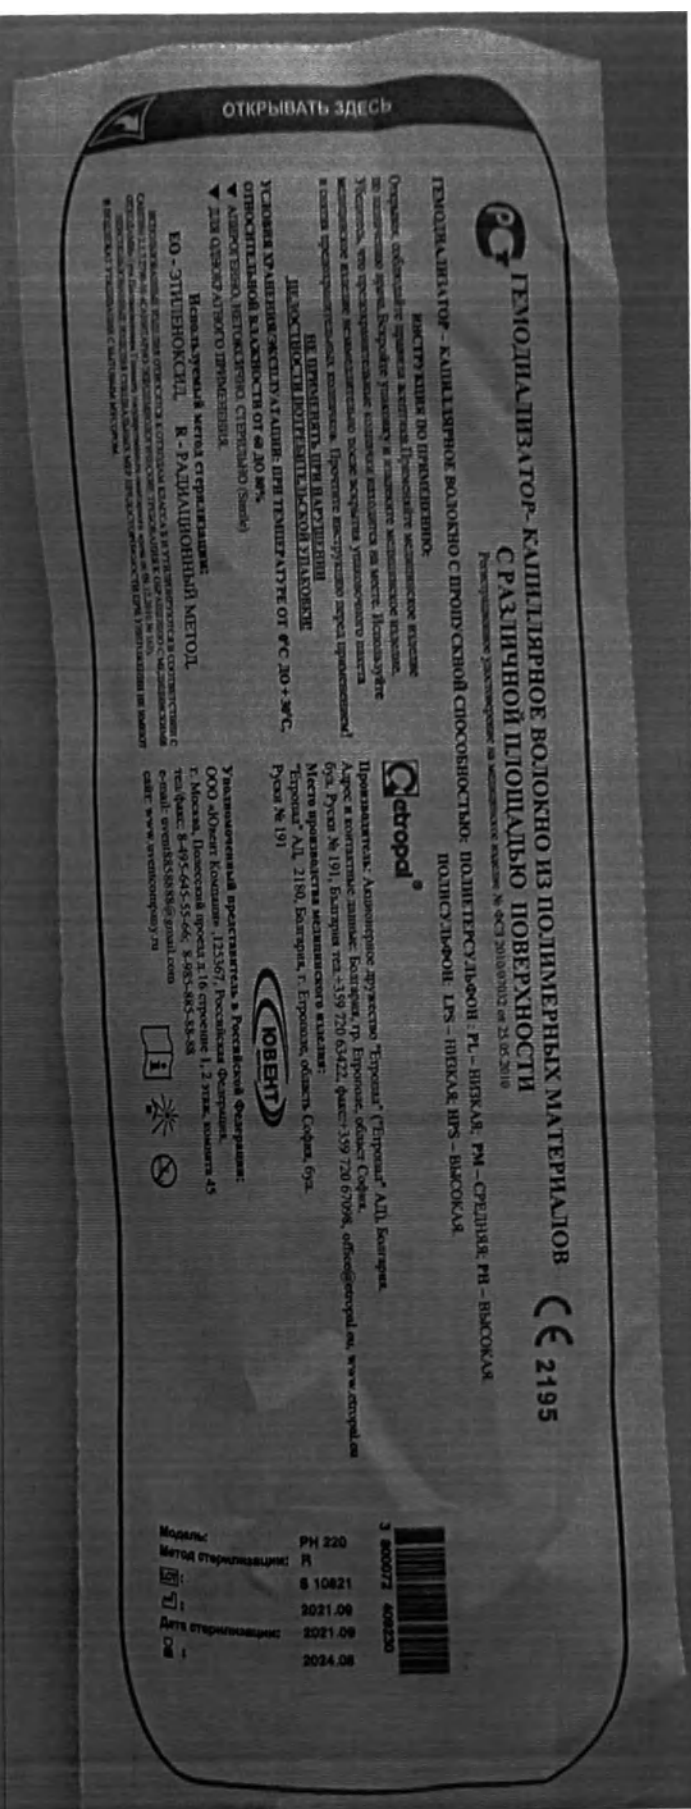


Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэтерсульфон с высокой пропускной способностью (PH), модель: PH 230

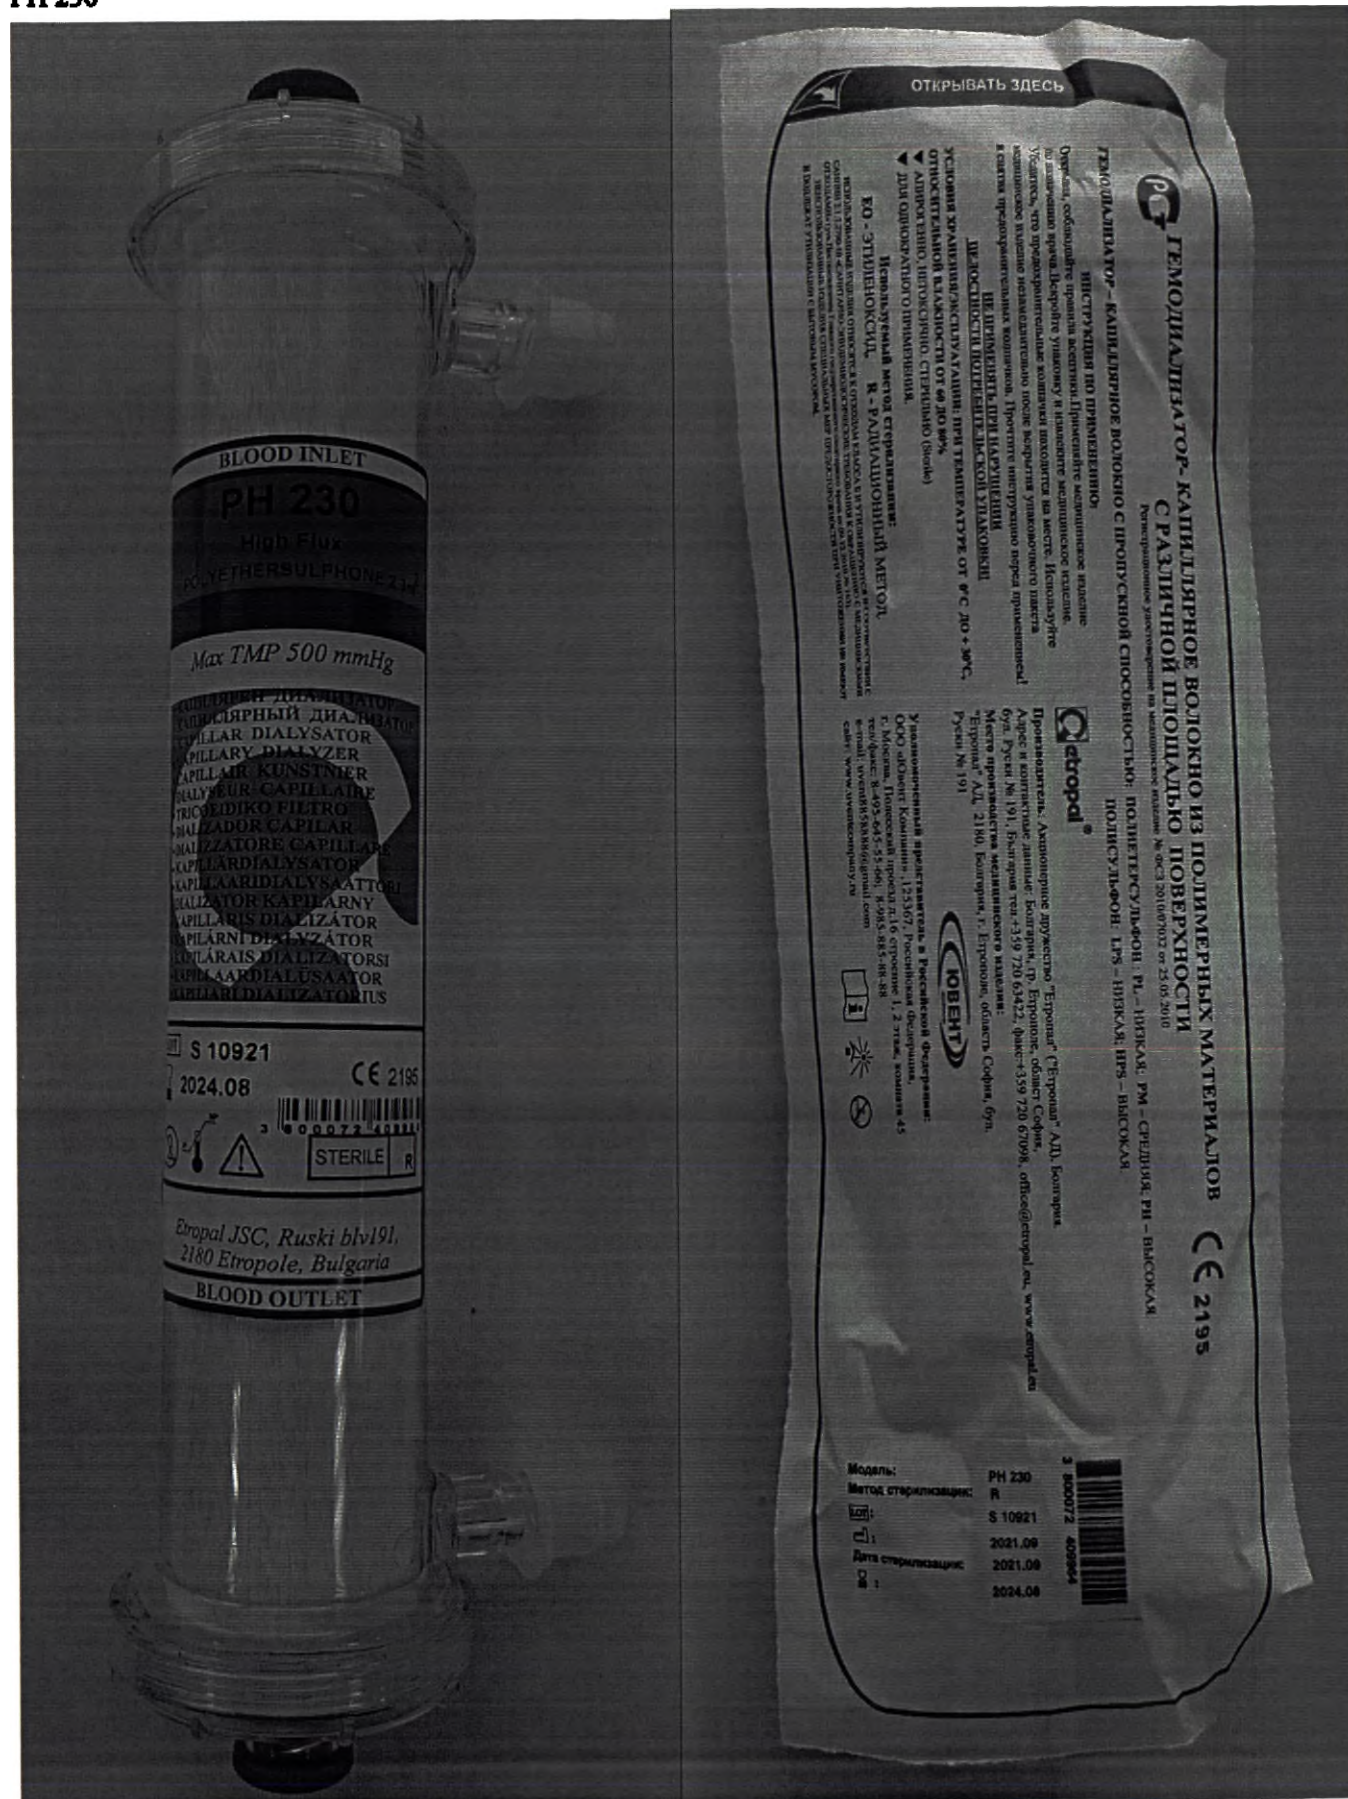

Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсульфон с высокой пропускной способностью (PH), модель: PH 240

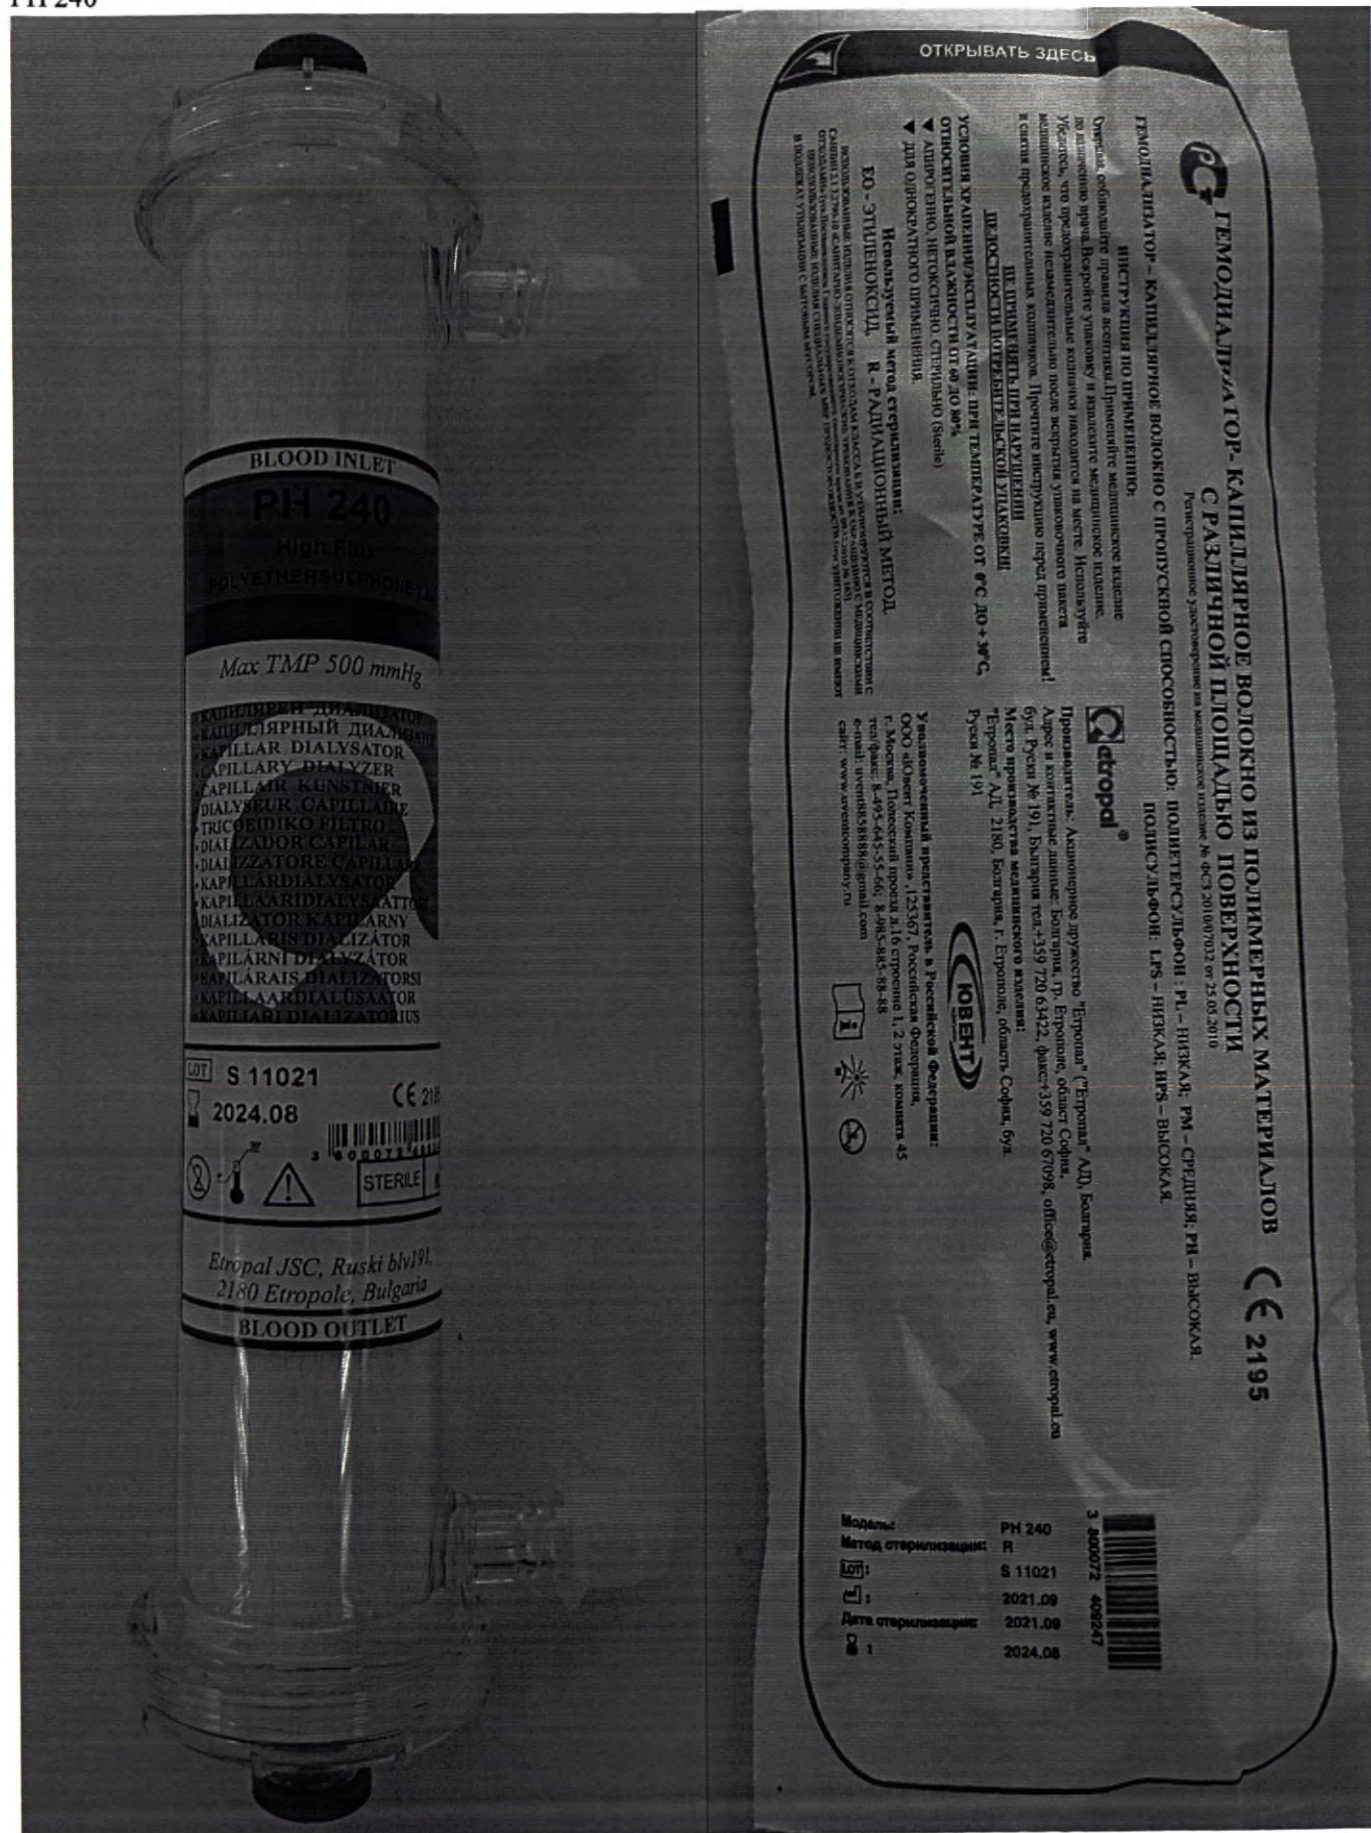


Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсульфон с высокой пропускной способностью (PH), модель: PH 250




Гемодиализатор - капиллярное волокно из полимерных материалов с различной площадью поверхности, вариант исполнения:

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиэтерсульфон с высокой пропускной способностью (PH), модель: PH 260

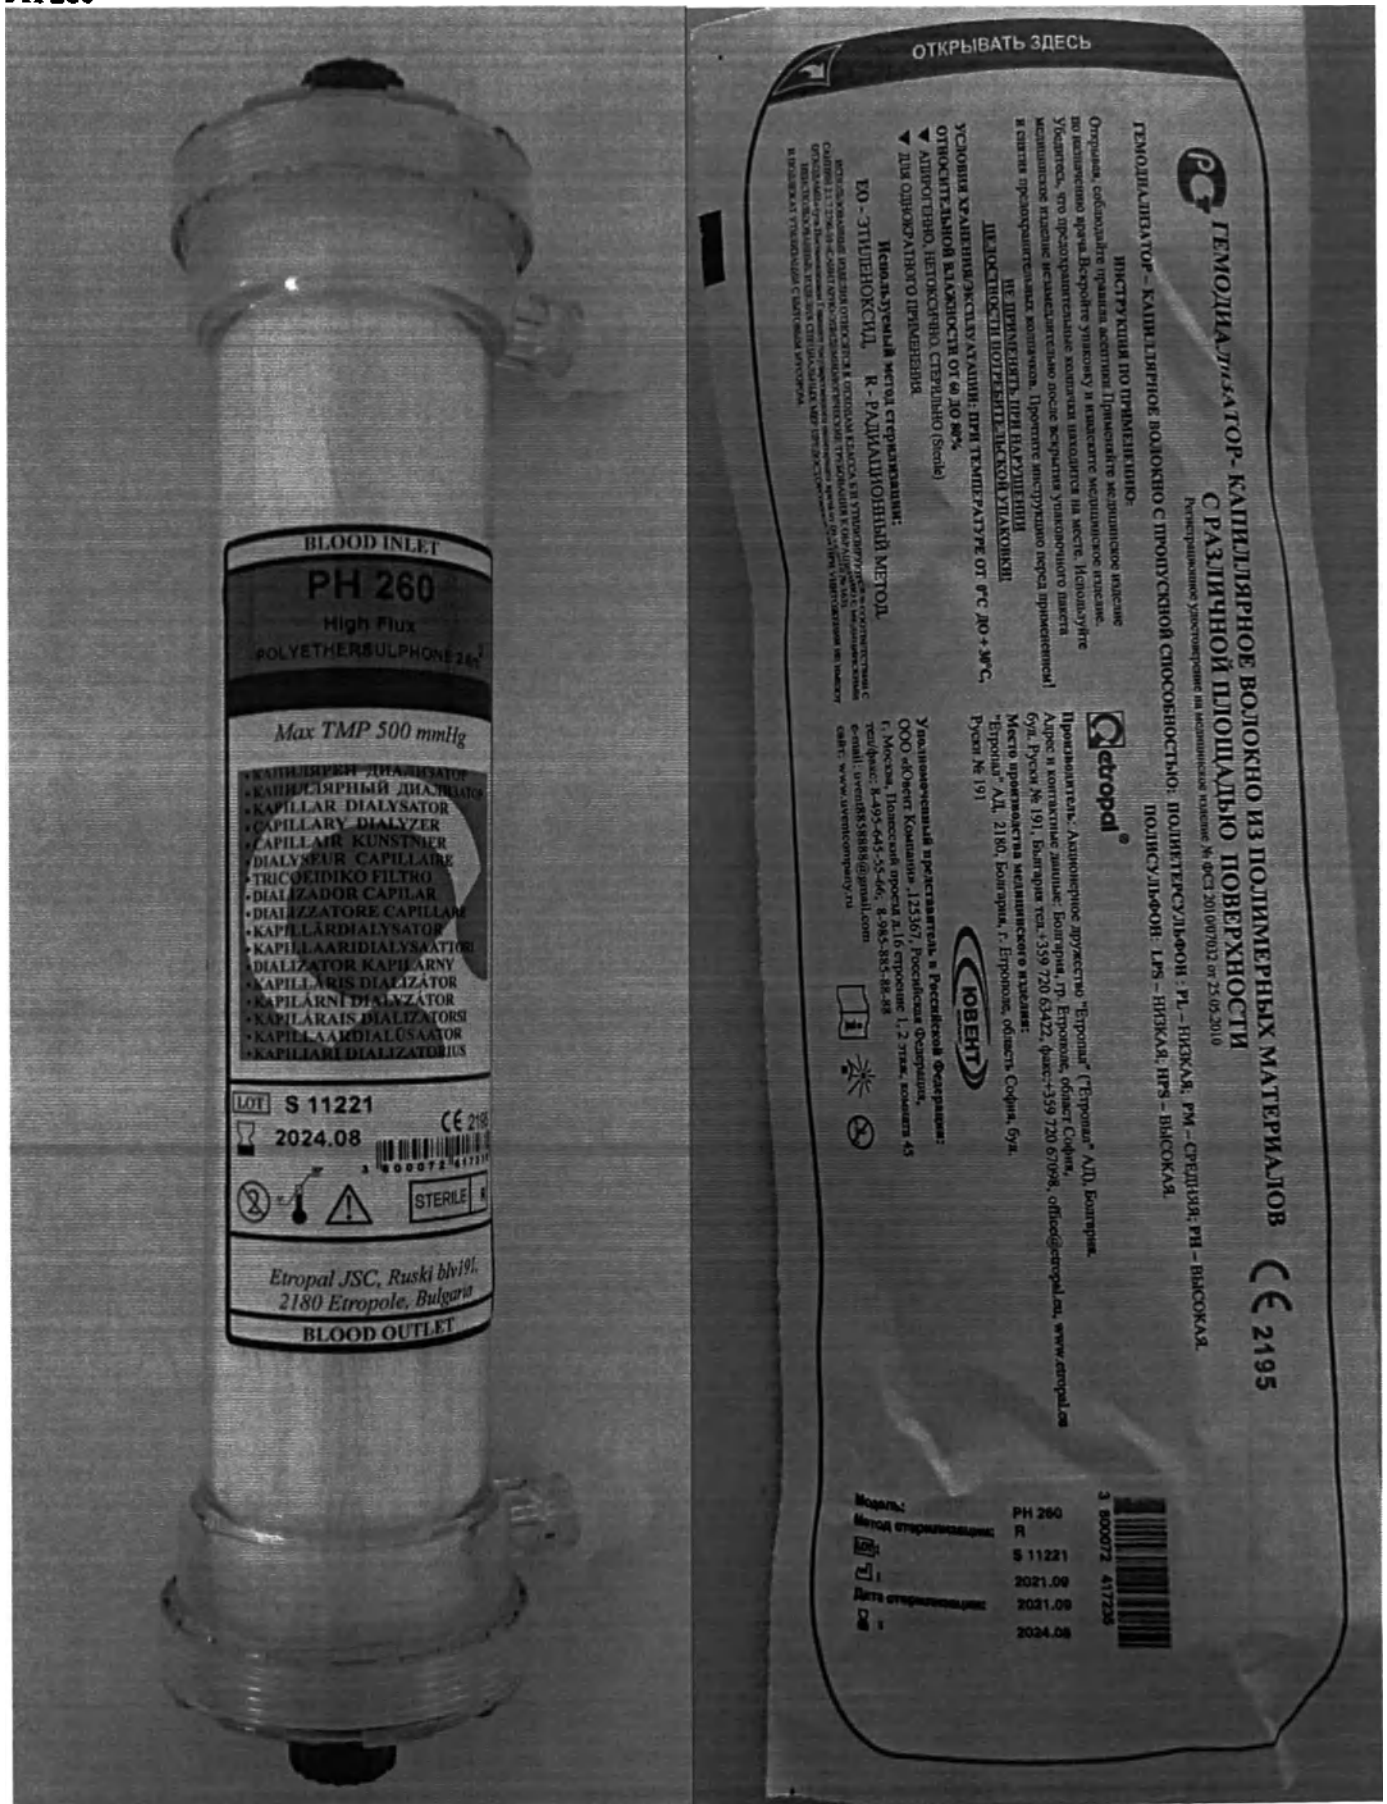

Гемодиализатор - капиллярное волокно Полиетерсульфон с высокой пропускной способностью (РН), модель: РН 270

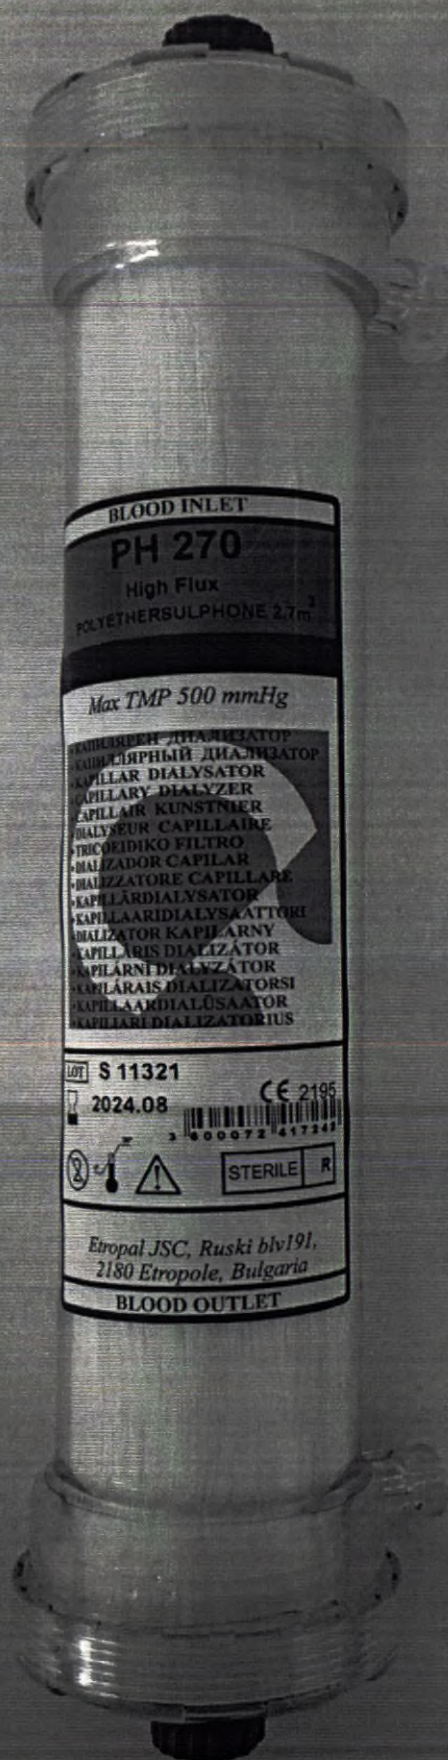

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



ГЕМОДИАЛИЗАТОР-КАПИЛЛЯРНОЕ ВОЛОКНО ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ПОВЕРХНОСТИ

C 2195

Перепечатанные удостоверения на металлическое изделие № ФПС 2010/07032 от 25.05.2011 г.

ПОЛИСУЛЬФОН: LPS - НИЗКАЯ, HPS - ВЫСОКАЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Организм, подвергаясь такому воздействию, испытывает сильнейшее напряжение, что приводит к развитию заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ, что способствует возникновению заболеваний на уровне. Необходимо учитывать, что воздействие химических веществ оказывает на нервную систему, вызывая нарушение обмена веществ. Поэтому необходимо принимать меры по предотвращению воздействия химических веществ. Поэтому необходимо принимать меры по предотвращению воздействия химических веществ.

**НЕ ПЕРЕМЕНИТЬ ПРИ РАДУШЕИИ
ТВОИХ ПОСЛАНИИ, ДУКОВ УНАКОВИИ**

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ/ЭКСПЛУАТАЦИИ: ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 0°С ДО +30°С
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ОТ 60 ДО 80%

▲ ДЛЯ ОДНОРАТНОГО ПЛАМЕНЕНИЯ.

**Использование метода стерилизации;
R-радикальный метод;
R-этиленоксид.**

Меньше времени метод стерилизации
ПЛЕНОКСИТ. R-РАДИКАЛЬНЫЙ

ИЗВЕЩАНИЕ АВТОРА ОТНОСИТЕЛНО ОТКРЫТИЕ ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ
КАТЕГОРИИ 2.1.2766.10 КОМПОНЕНТЫ-ПРОДУКТЫ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ТРИАЛИЛАМИНА С ОКСИДОВИДНЫМ
ОТНОСИТЕЛЬНО ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ТРИАЛИЛАМИНА ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ

Универсальный партнерство в России
ООО «Ювент Компани», 125367, Российская Федерация,
г. Москва, Толмачевский проспект, д.10 строение 1, 2 этаж, комната 41
телефон: 8-499-645-35-66; 8-995-885-88-88
e-mail: juvent88888@gmail.com
сайт: www.juventcompany.ru



Приветствуем! Акционерное общество "Европост" ("Европост АД"), болгарский
Аудит и консалтинг дивизион: Болгария, г.г. Европост, офис София,
69, "Ручей" № 191. Болгария тел.: +359 720 634322; факс: +359 720 61098, office@europost.bg, www.europost.bg
Месте производства медианисковете класове:
"Европост" АД, 2180, Болгария, г. Европост, офис София, бг.
Ручей № 191



Модель:	PH 270
Метод стерилизации:	Я
Lot:	6 11321
Год:	2021.08
Дата стерилизации:	2021.08
Год:	2024.08

Сшито и заверено печатью 91
(Десятого один) лист

Генеральный директор
ООО «Ювент Компани»
Николайчев А.Л.

