




Фотографии медицинского изделия
Аппарат рентгенографический палатный
передвижной «МобиРен-5-МТ»,
производства АО «МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия

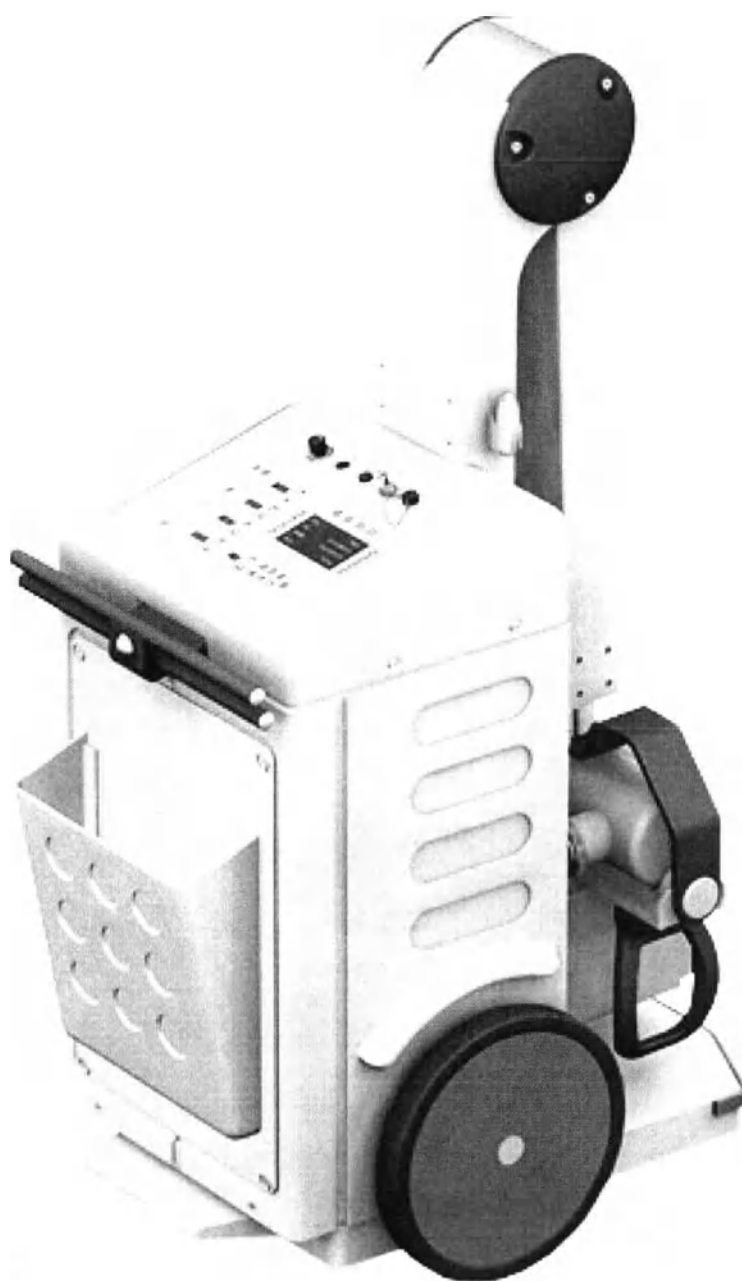


**Аппарат рентгенографический палатный
передвижной «МобиРен-5-МТ» исполнение А,
производства АО «МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия**

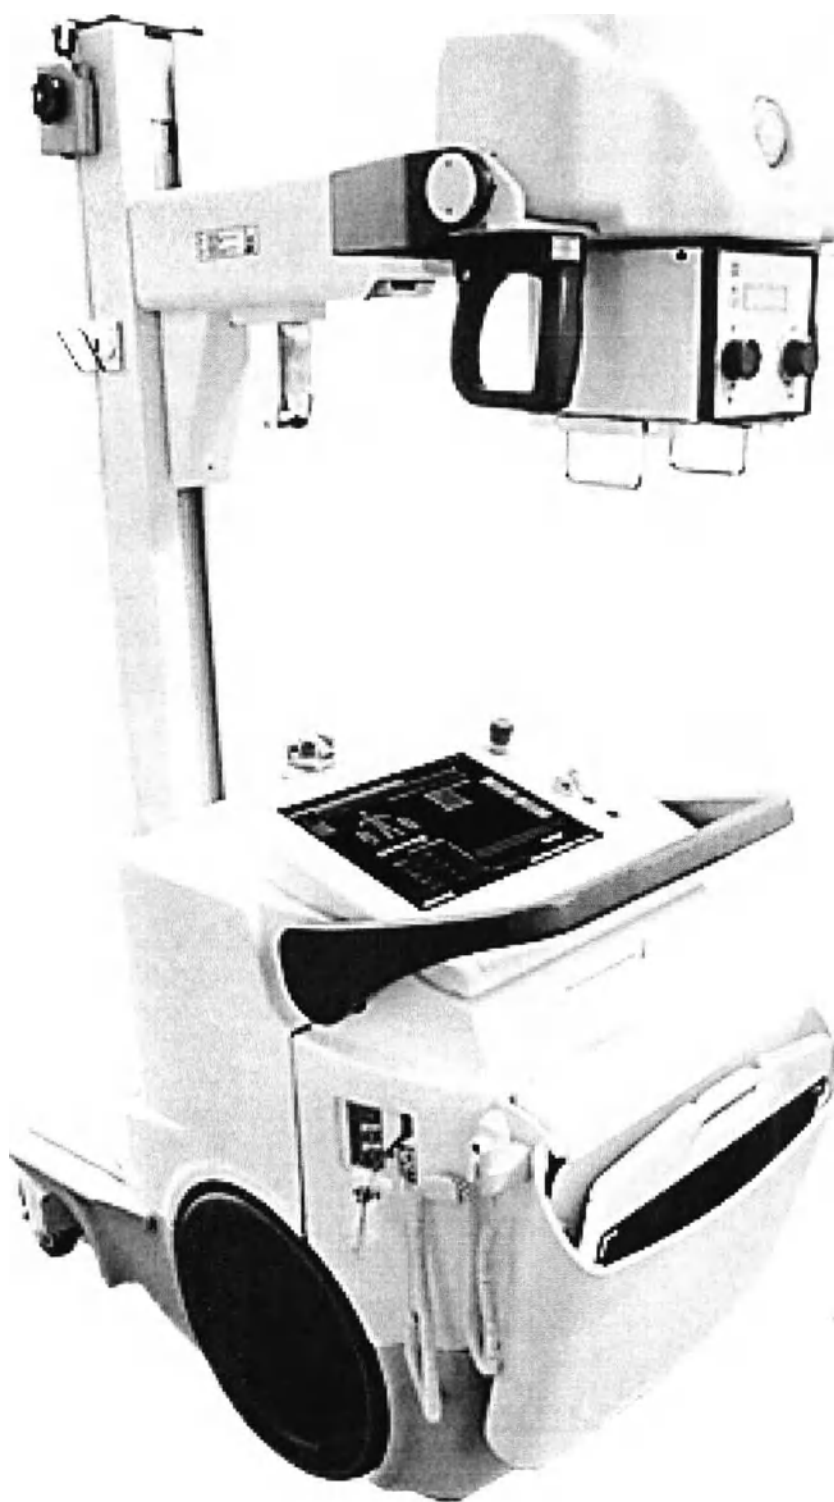

**Аппарат рентгенографический палатный
передвижной «МобиРен-5-МТ» исполнение Б,
производства АО «МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия**

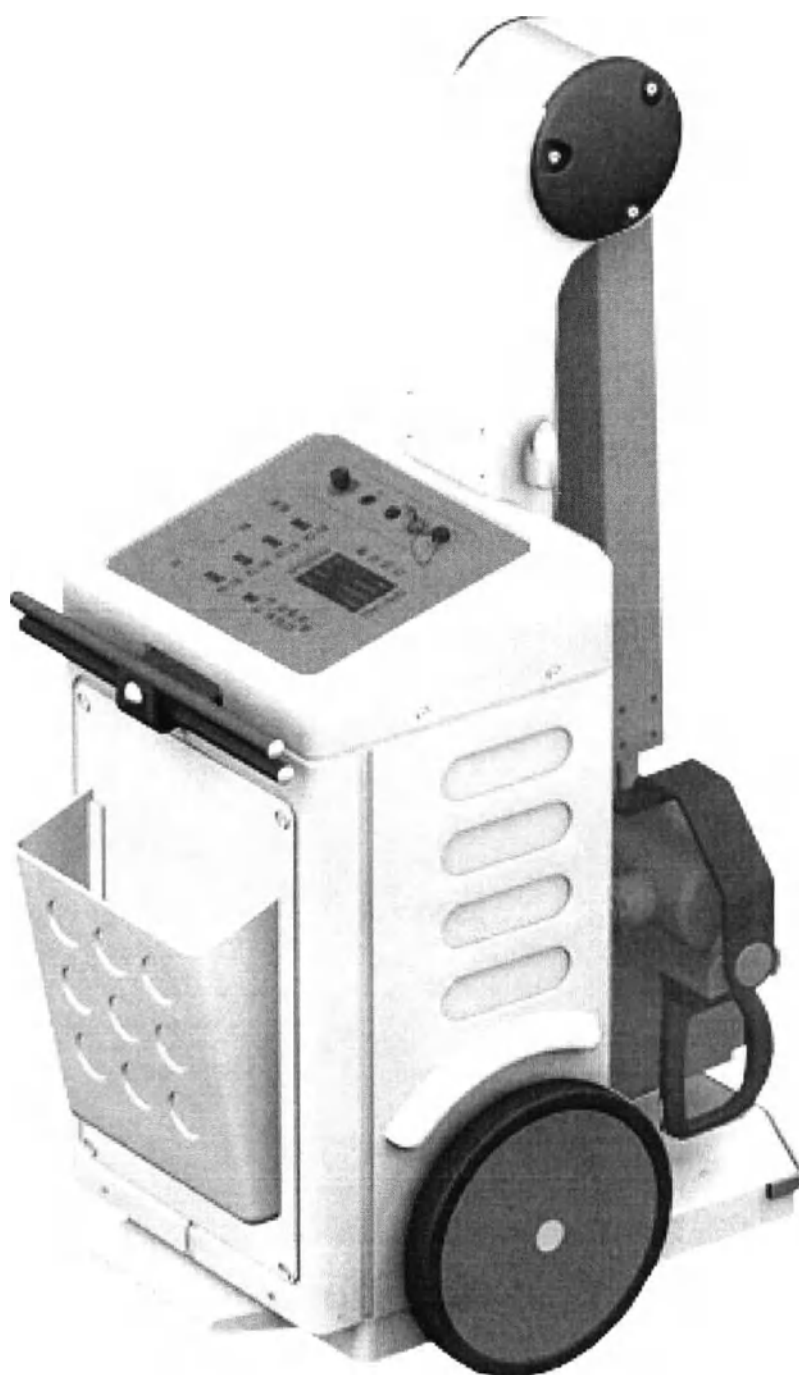


**Штатив базовый облегчённый, производства
фирмы Sedecal S.A., Испания**

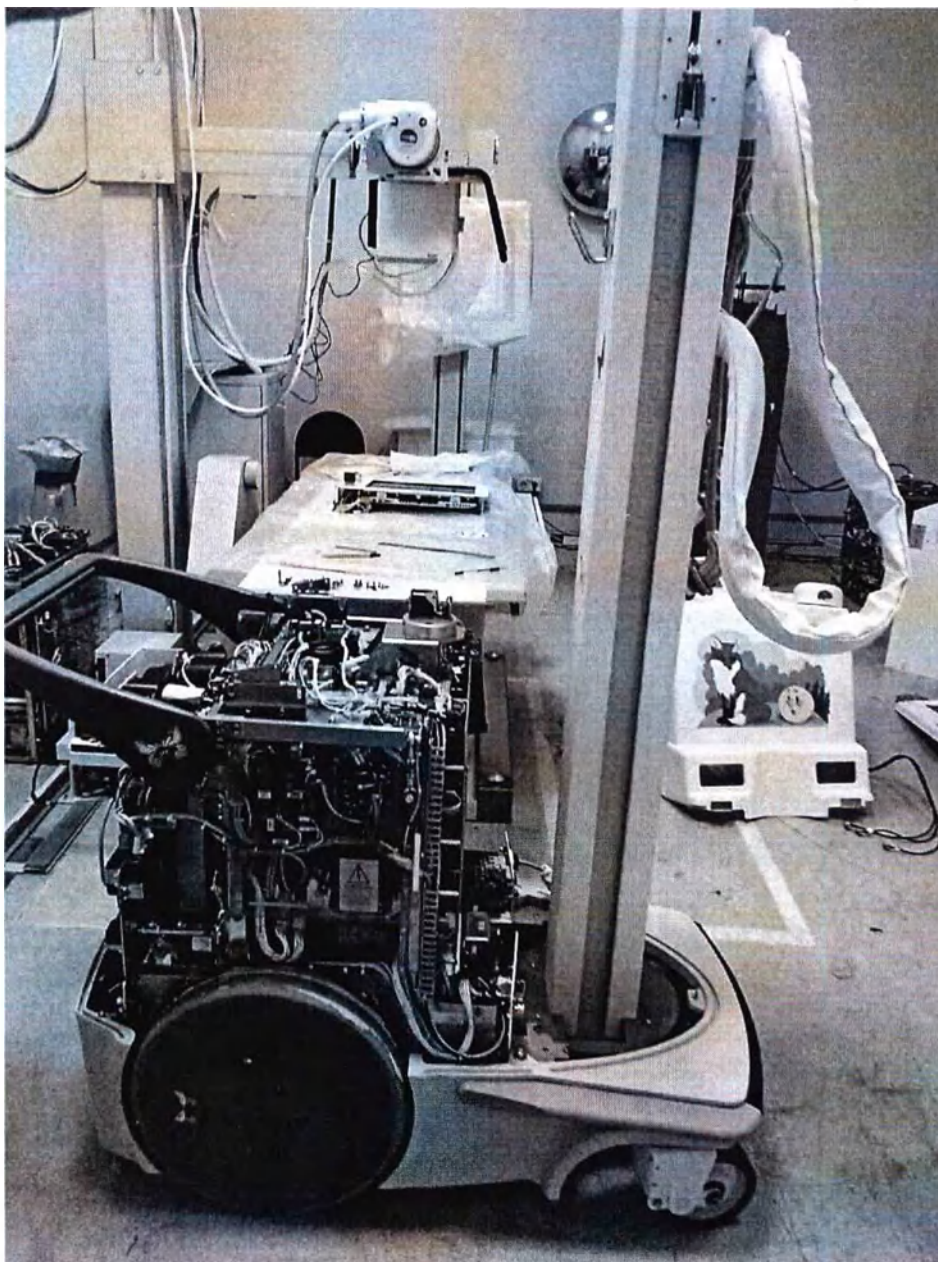


**Штатив моторизованный, производства
фирмы Sedecal S.A., Испания**



**Стрела штатива фиксированная,
производства фирмы Sedecal S.A., Испания**

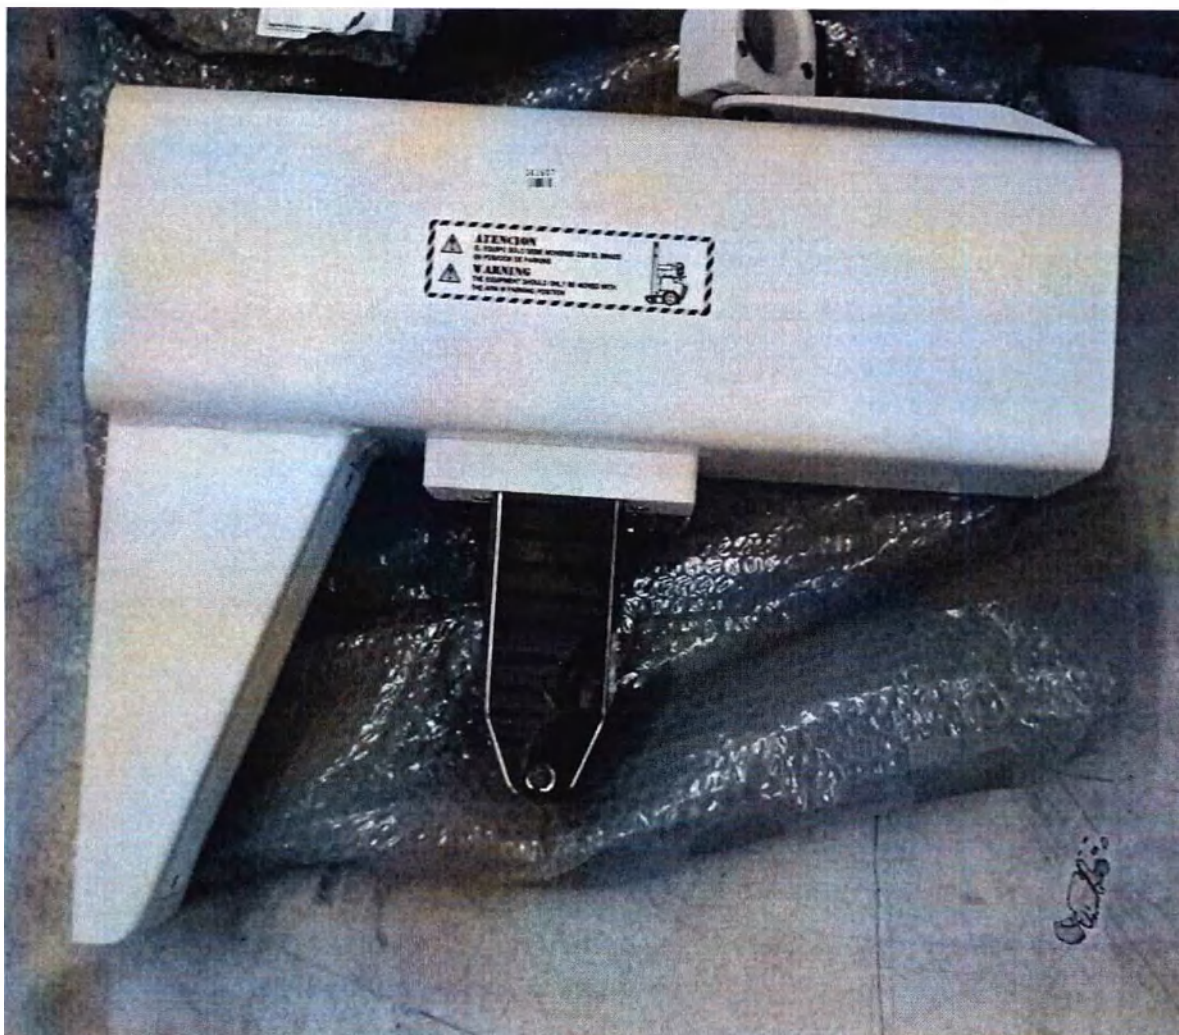

**Стрела штатива телескопическая,
производства фирмы Sedecal S.A., Испания**

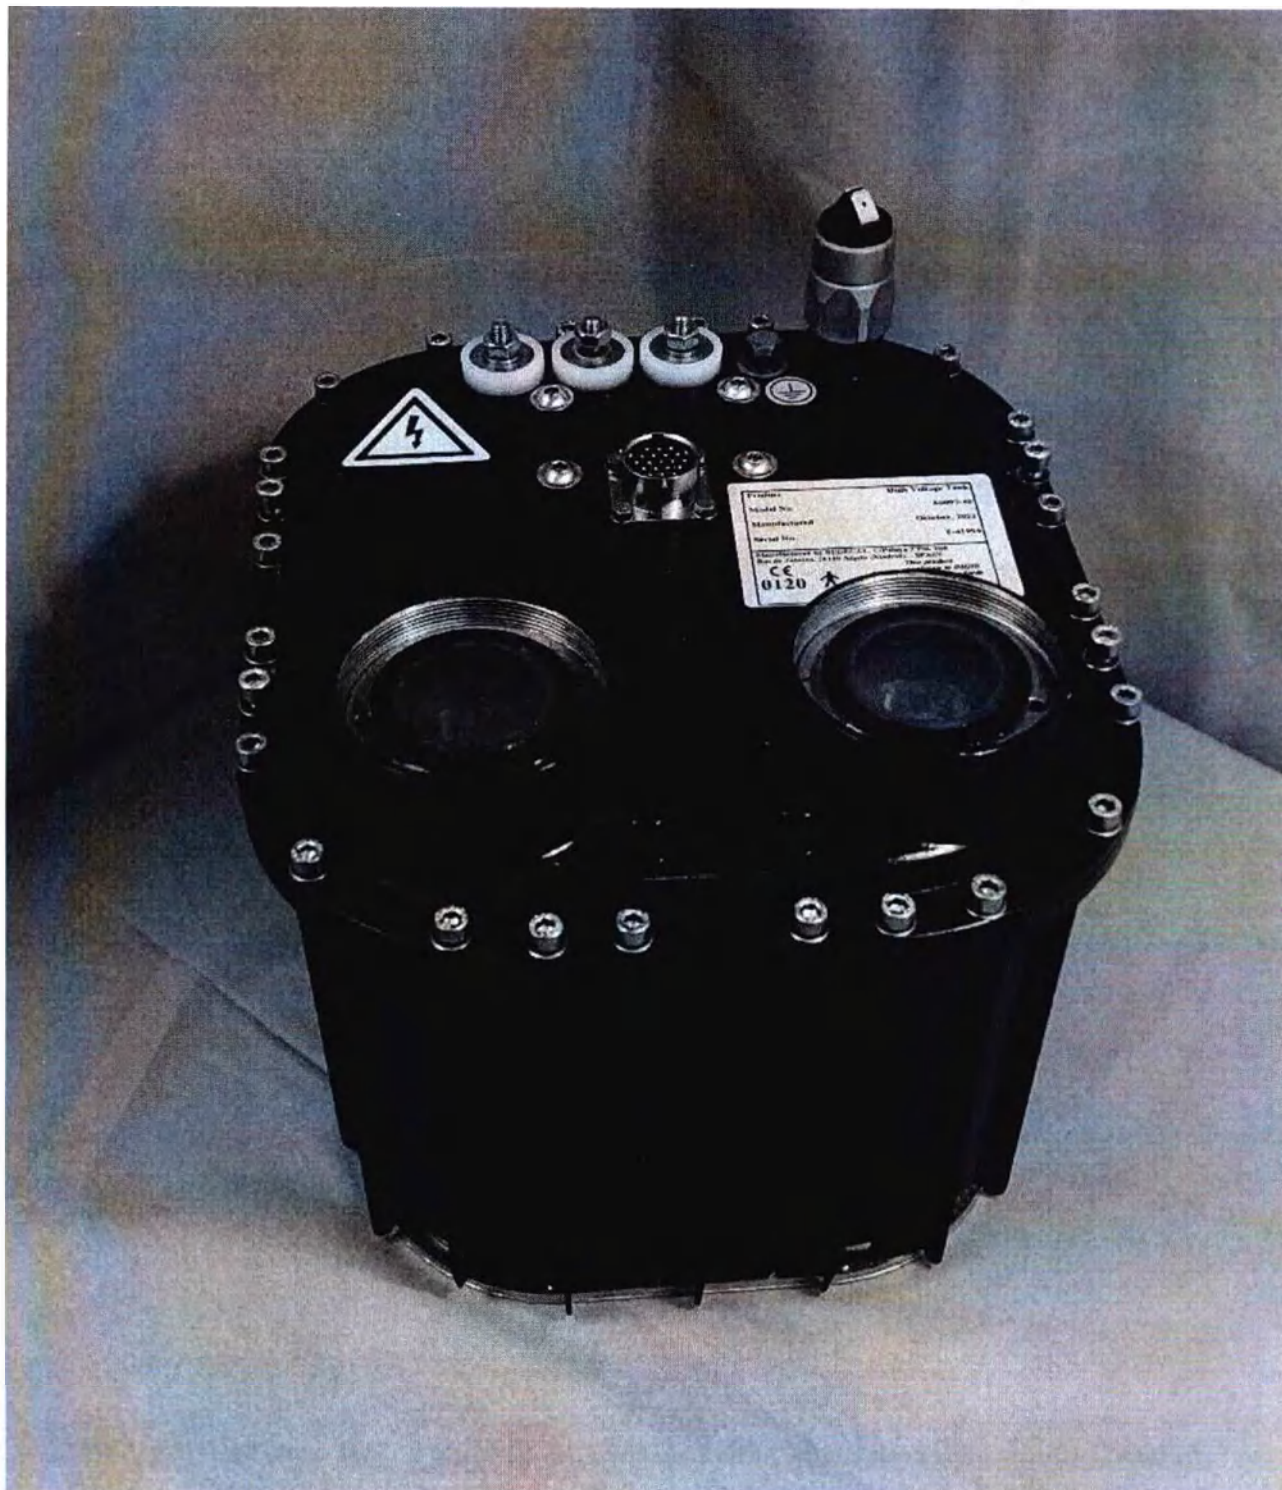

Рентгеновское питающее устройство (генератор), без блока рентгенэкспонетра или с блоком рентгенэкспонетра, производства фирмы Sedecal S.A., Испания, варианты

исполнения:


- SMR-16 HF**
- SMR-20 HF**
- SMR-32 HF**




Рентгеновское питающее устройство (генератор), без блока рентгенэкспонетра или с блоком рентгенэкспонетра, производства фирмы Sedecal S.A., Испания, варианты

исполнения:


- SM-20 HF**
- SM-32 HF**
- SM-40 HF**
- SM-50 HF**

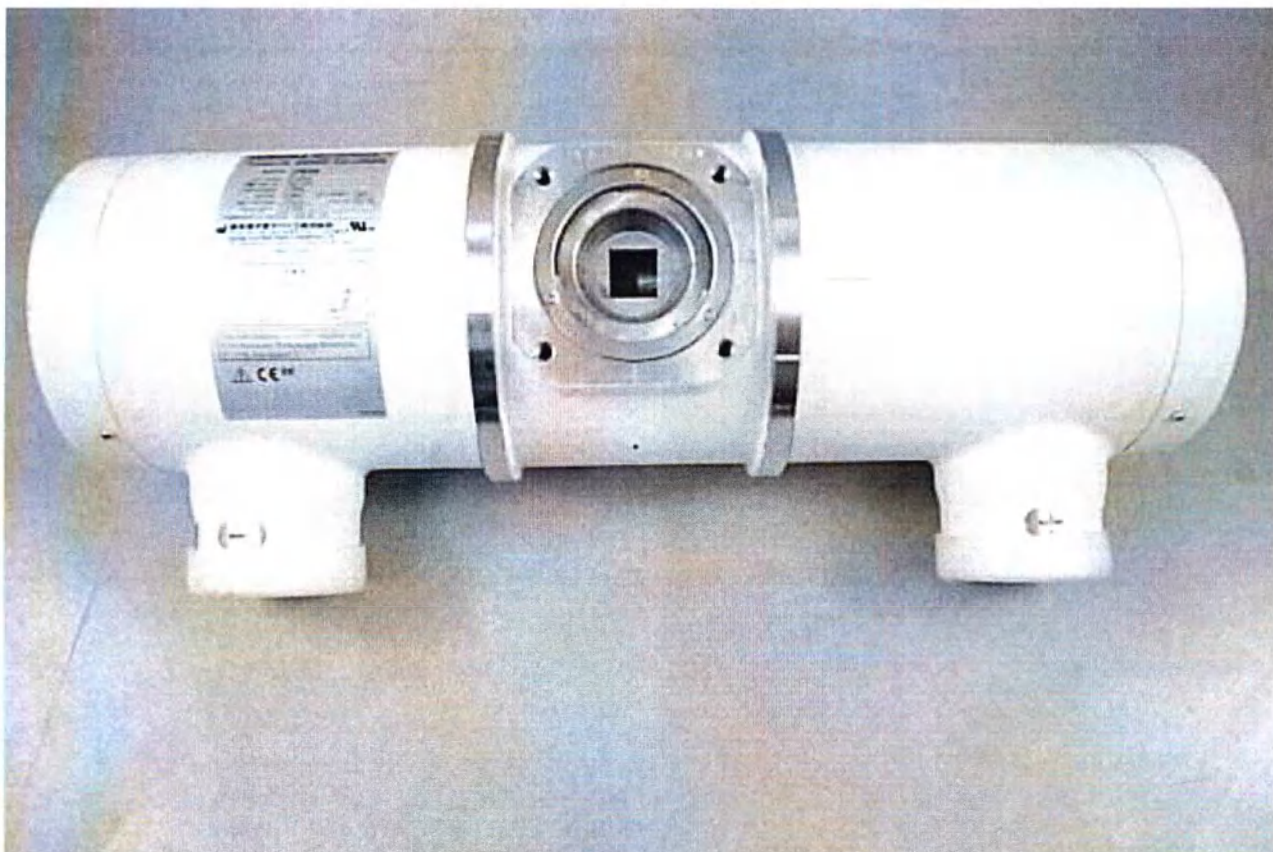

**Рентгеновская трубка, производства фирмы Canon Electron Tubes&Devices Co., Ltd., Япония, варианты исполнения:
- E7865X, E7843X, E7886X, E7884X**

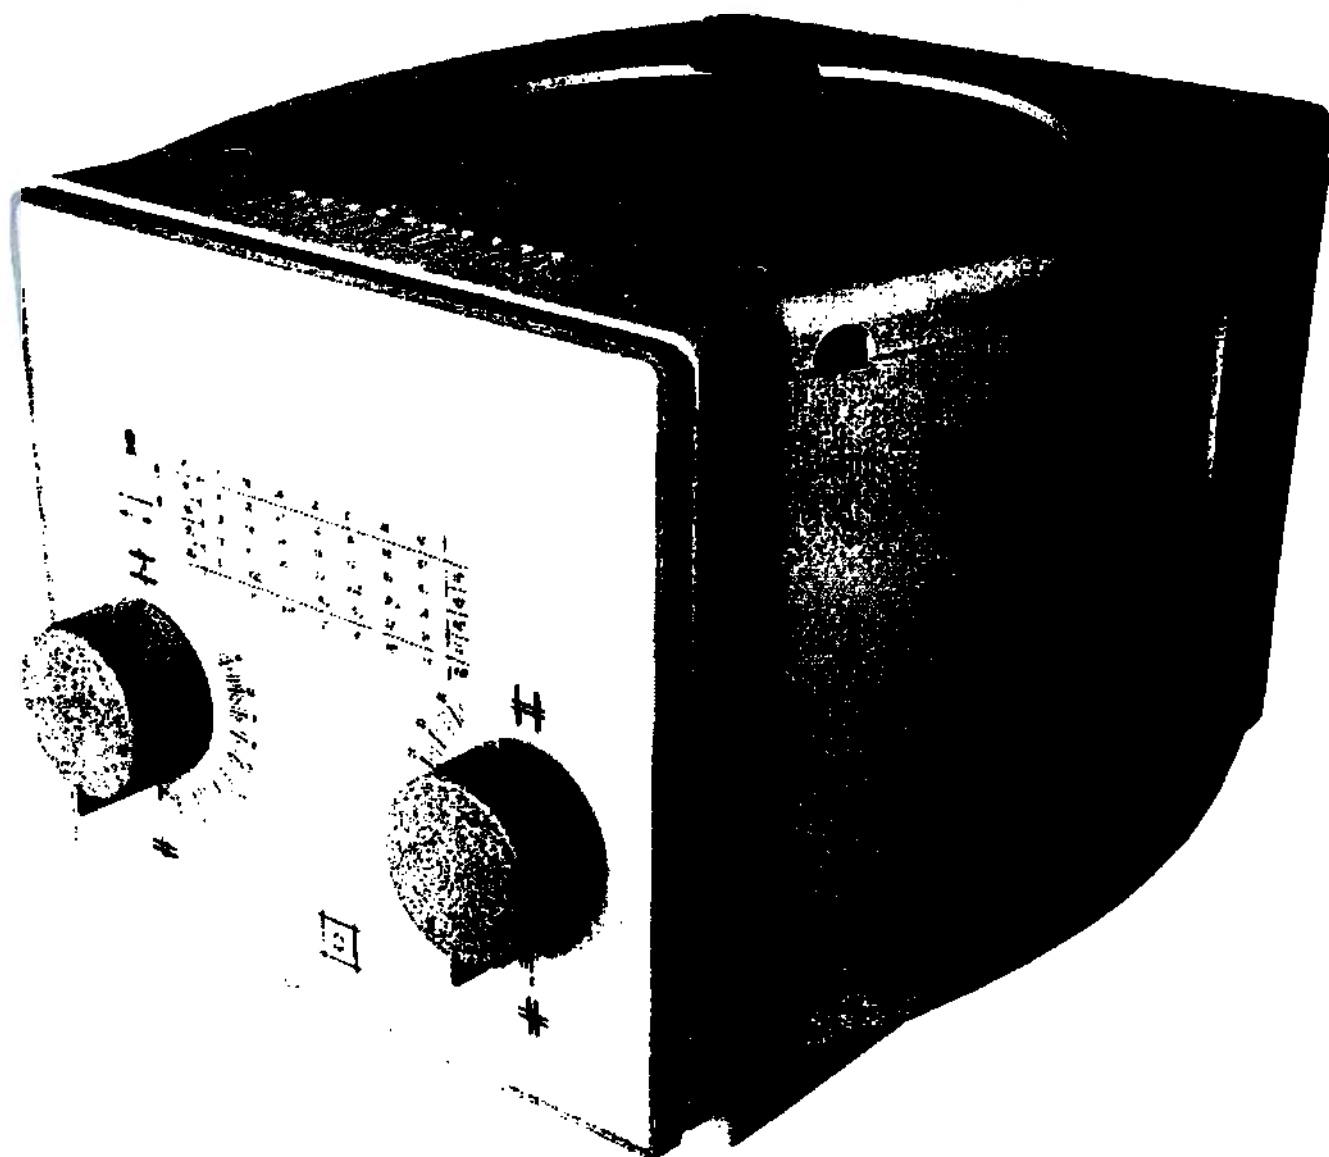

Коллиматор серии R, производства фирмы Ralco S.r.l, Италия

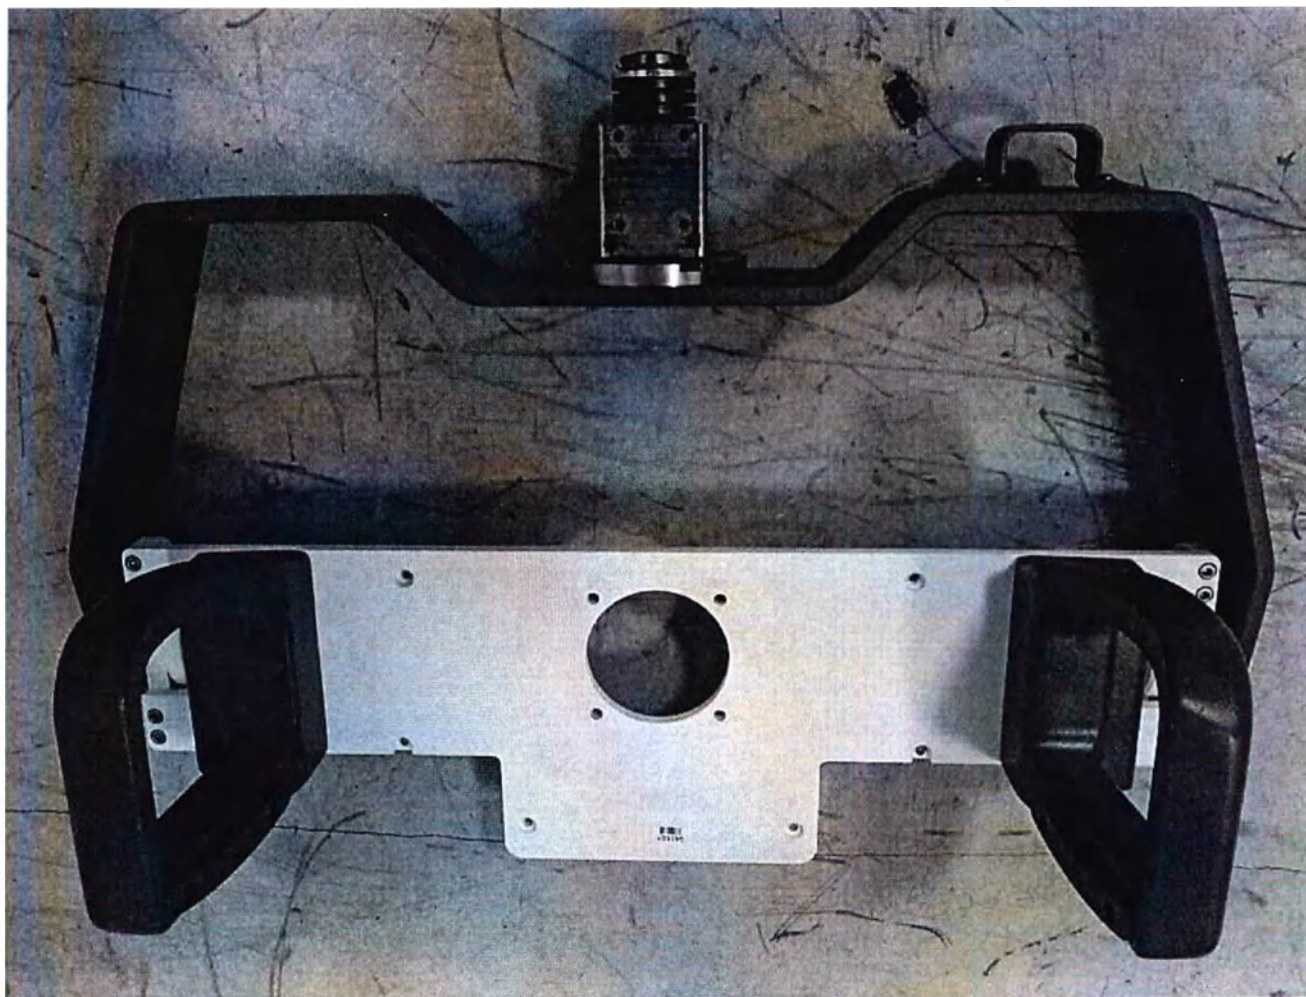


**Держатель рентгеновской трубки с рукоятками, производства
фирмы Sedecal S..A., Испания**




Задний кожух, производства фирмы Sedecal S.A., Испания




Верхний кожух, производства фирмы Sedecal S.A., Испания

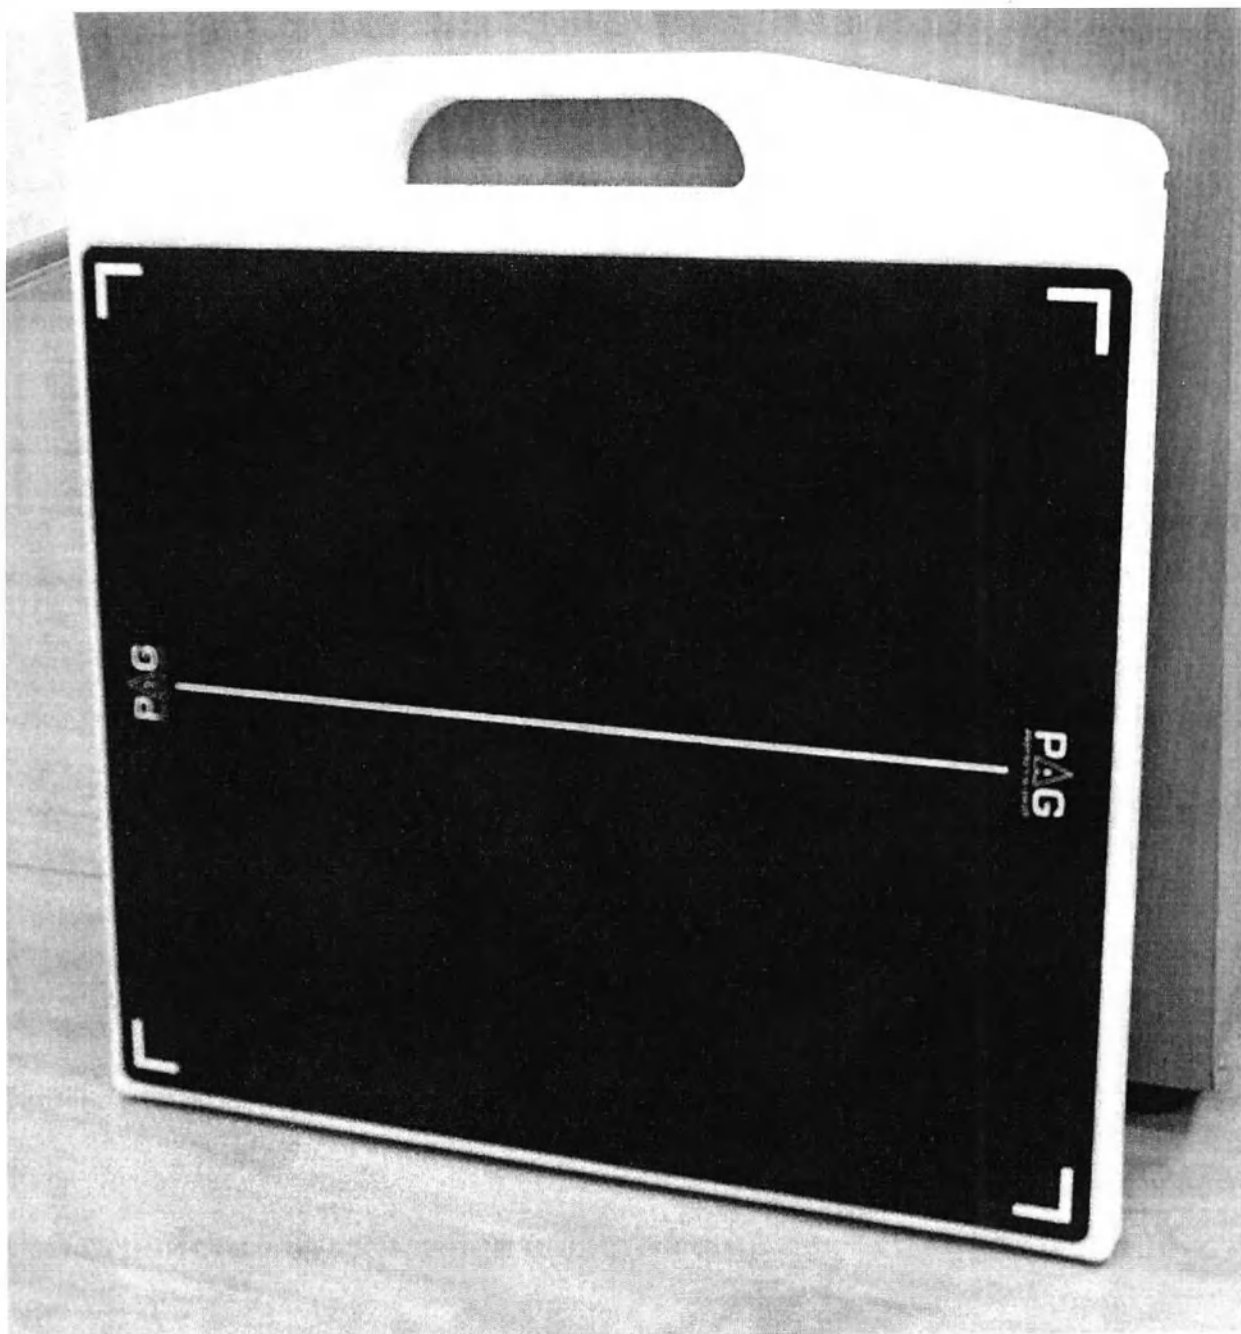

Растр ACS, производства фирмы JPI, Корея

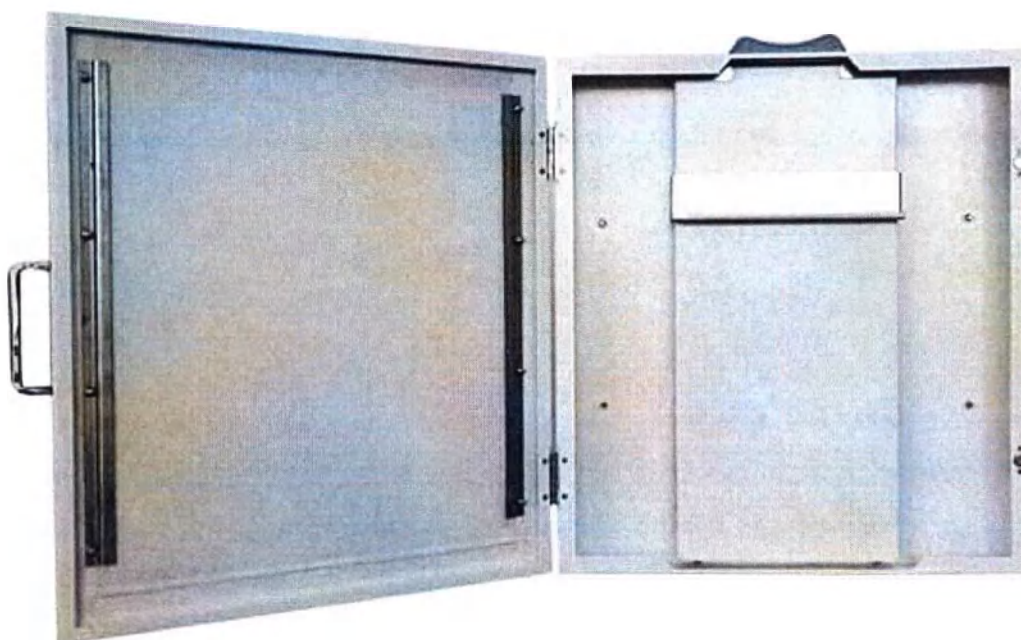


Устройство будки, производства фирмы THALES, Франция

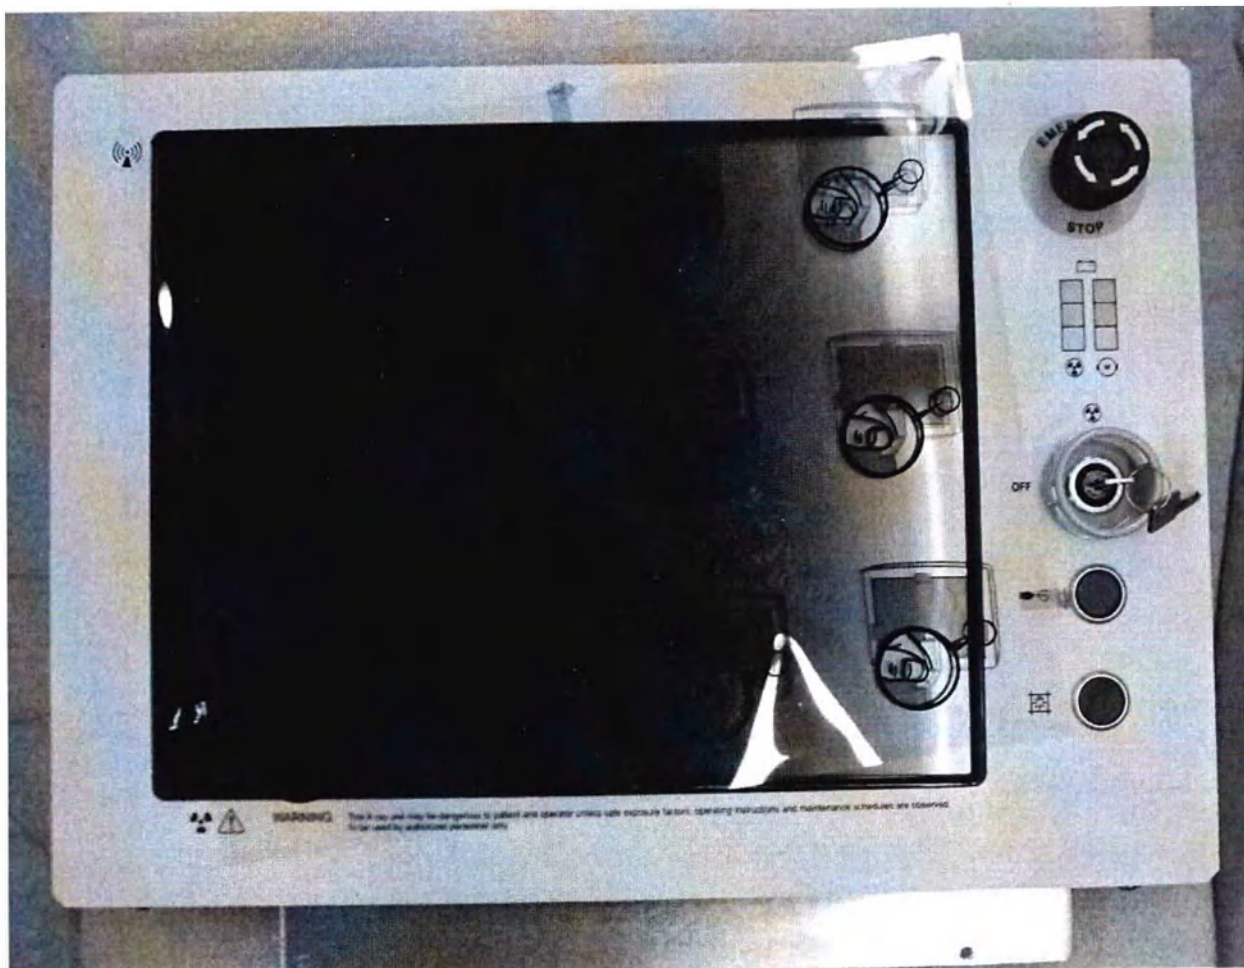

**Консоль управления в сборе базовая, производства фирмы
Sedecal S.A., Испания**





**Консоль управления в сборе модифицированная (в составе с
тач-скрин дисплеем), производства фирмы ELO TouchSystems,
Китай**

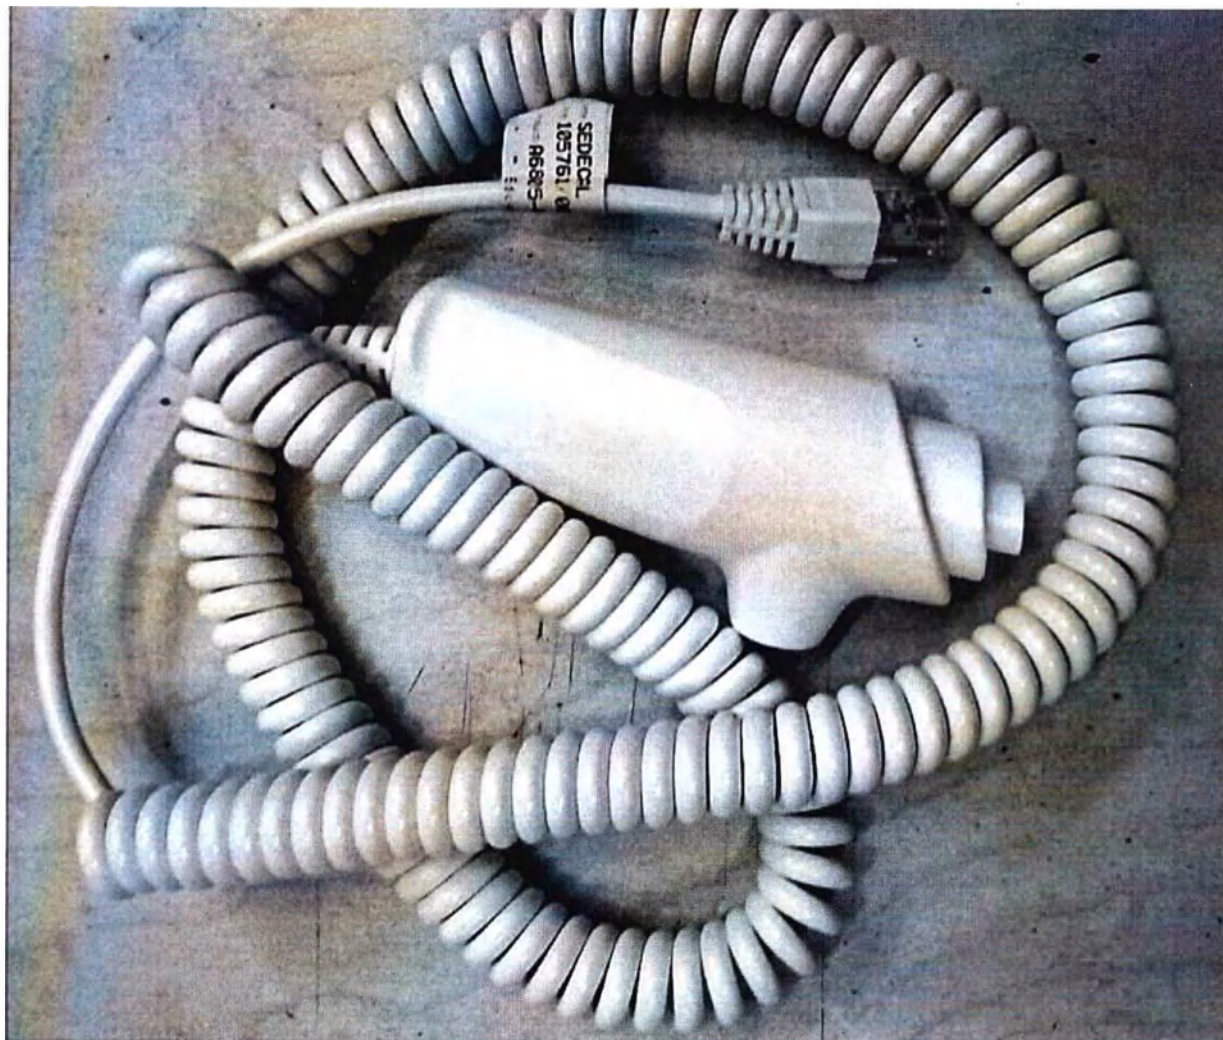

**Устройство дистанционного включения экспозиции,
производства фирмы Sedecal S.A., Испания**




**Комплекс аппаратно-программный для регистрации и
обработки рентгеновских изображений «СОЛО ДР-МТ» по ТУ
26.60.11-059-47245915-2017, исполнение «СОЛО ДР-МТ»-2.1,
производства фирмы АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Лтд», Россия**

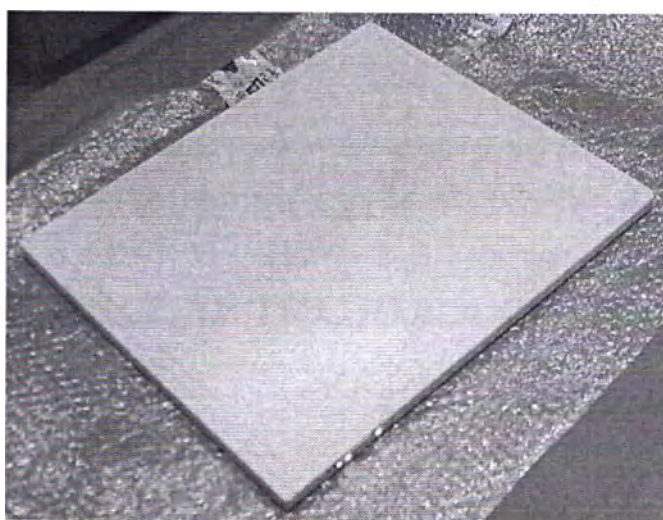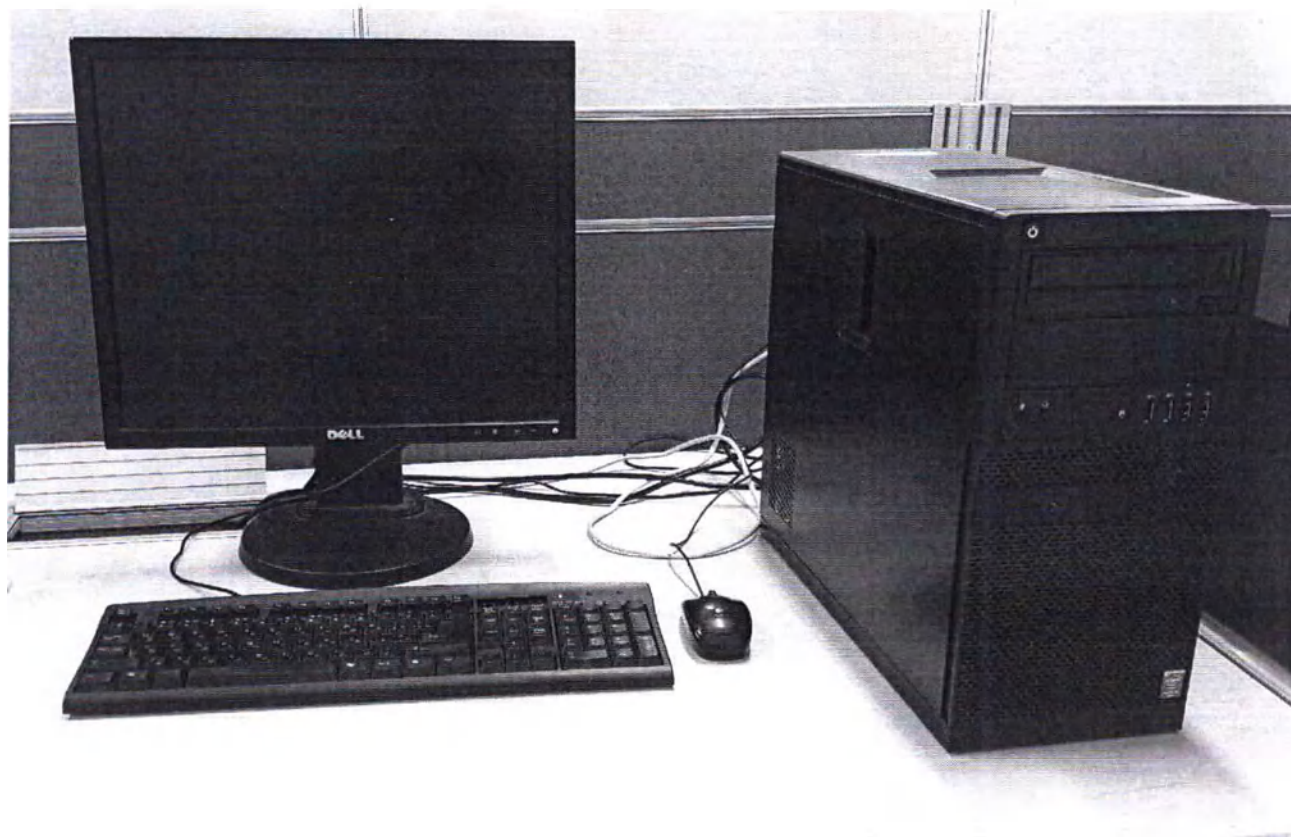

**Комплекс аппаратно-программный для регистрации и
обработки рентгеновских изображений «СОЛО ДР-МТ» по ТУ
26.60.11-059-47245915-2017, исполнение «СОЛО ДР-МТ»-2.4,
производства фирмы АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Лтд», Россия**



**Автоматизированное рабочее место врача рентгенолога
«ДИАРМ - МТ - Плюс» по ТУ 26.60.12-064-47245915-2018,
исполнение «ДИАРМ-МТ-Плюс»-2, производства фирмы АО
«МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия**

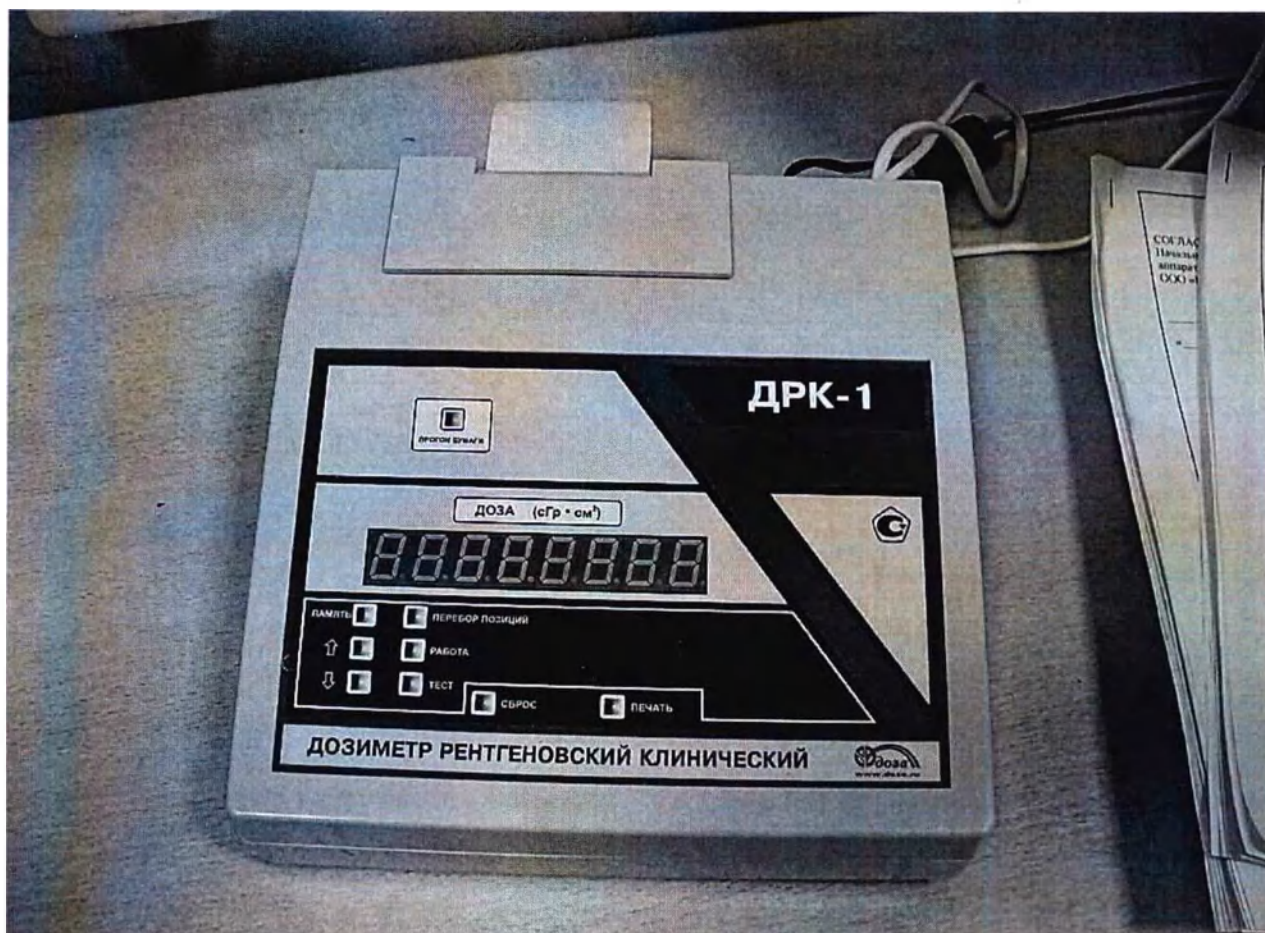


**Дозиметр рентгеновского излучения ДРК-1 однокамерный,
производства фирмы НПП «Доза», Россия**



Устройство печати цифровых диагностических медицинских изображений «Horizon», производства фирмы Codonics, Inc., США




Носители пленочные для термической печати диагностических медицинских изображений Direct Vista 14"x17" (35x43 см) (100 л.), производства фирмы Codonics, Inc., США

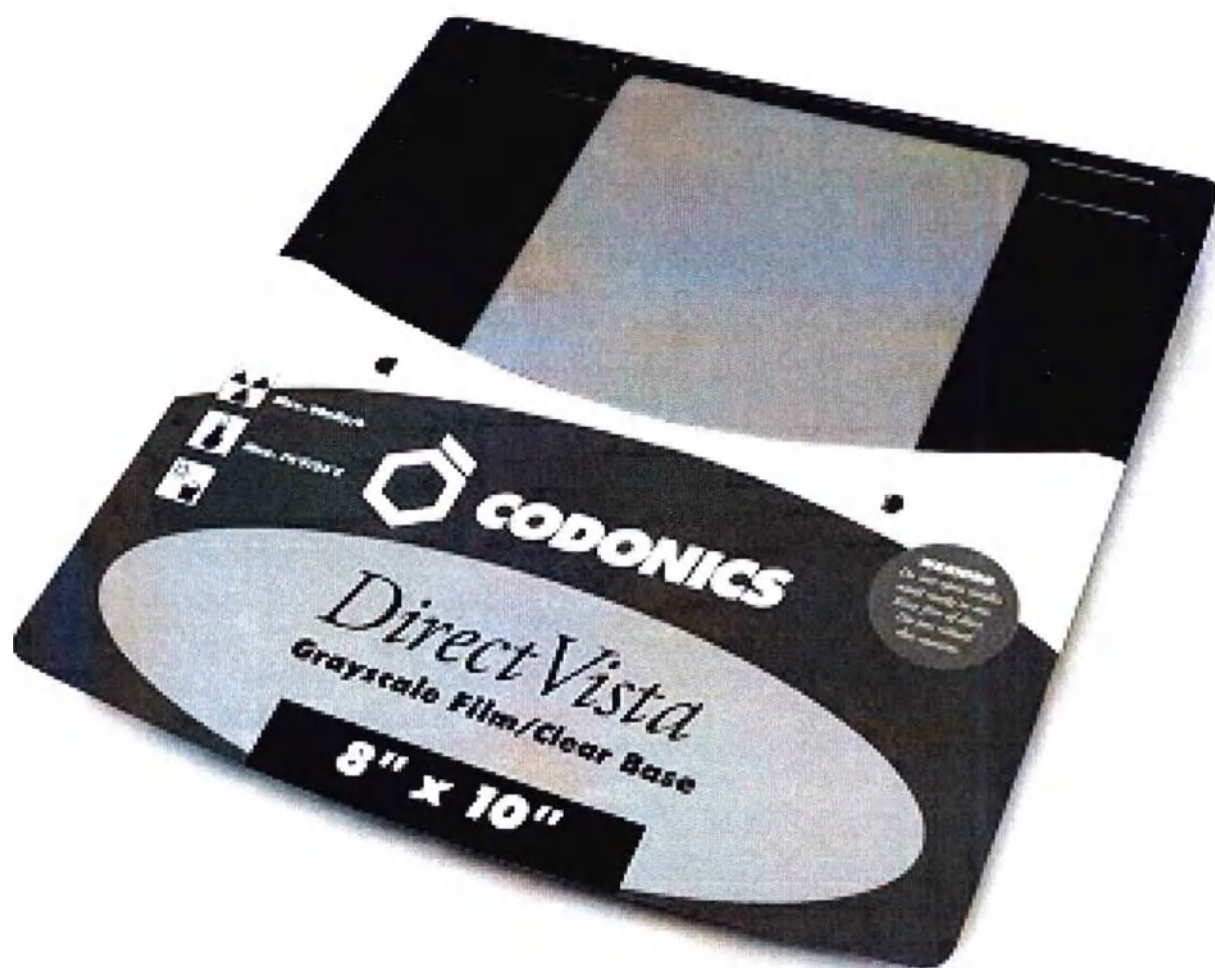

Носители пленочные для термической печати диагностических медицинских изображений Direct Vista 8"x10" (20x25 см) (100 л.), производства фирмы Codonics, Inc., США



**Мобильная стойка снимков, производства фирмы АО
«МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия**

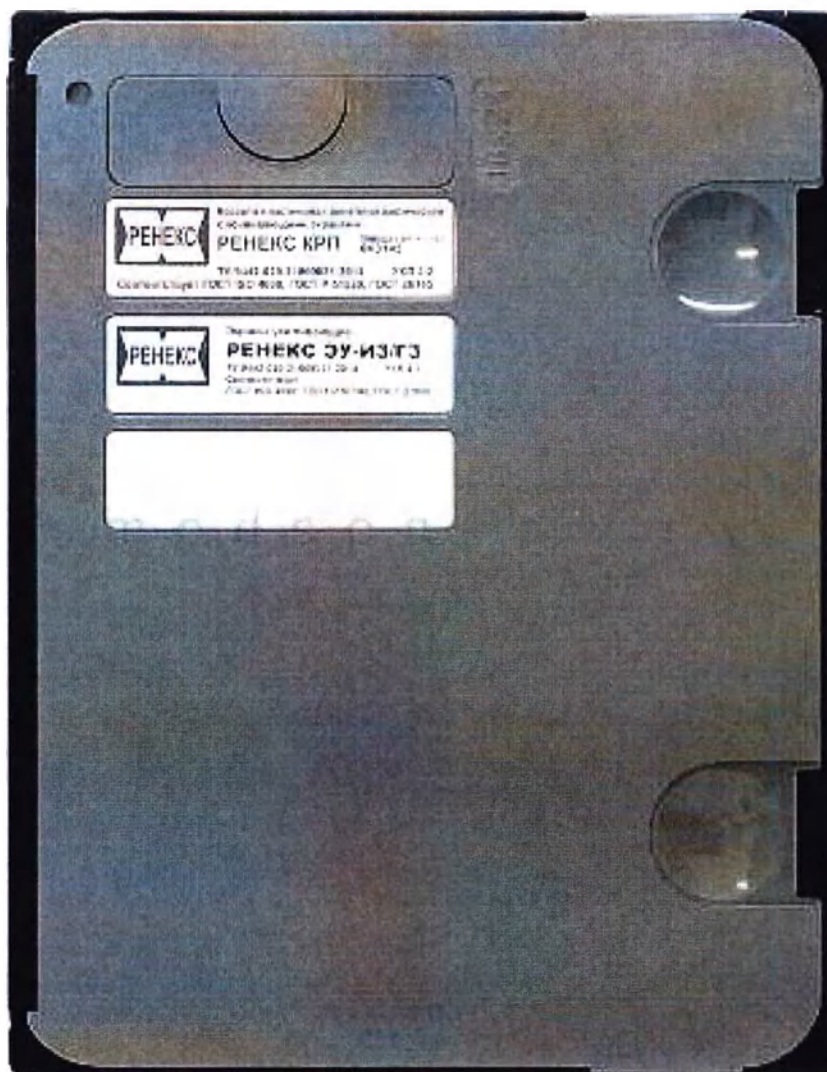


**Комплект рентгеновских кассет, производства фирмы ЗАО
«РЕНЕКС», Россия**




**Комплект рентгеновских кассет, производства фирмы
Carestream Health Inc. (Kodak), США**




**Комплект рентгеновских кассет, производства фирмы Agfa
N.V., Бельгия**

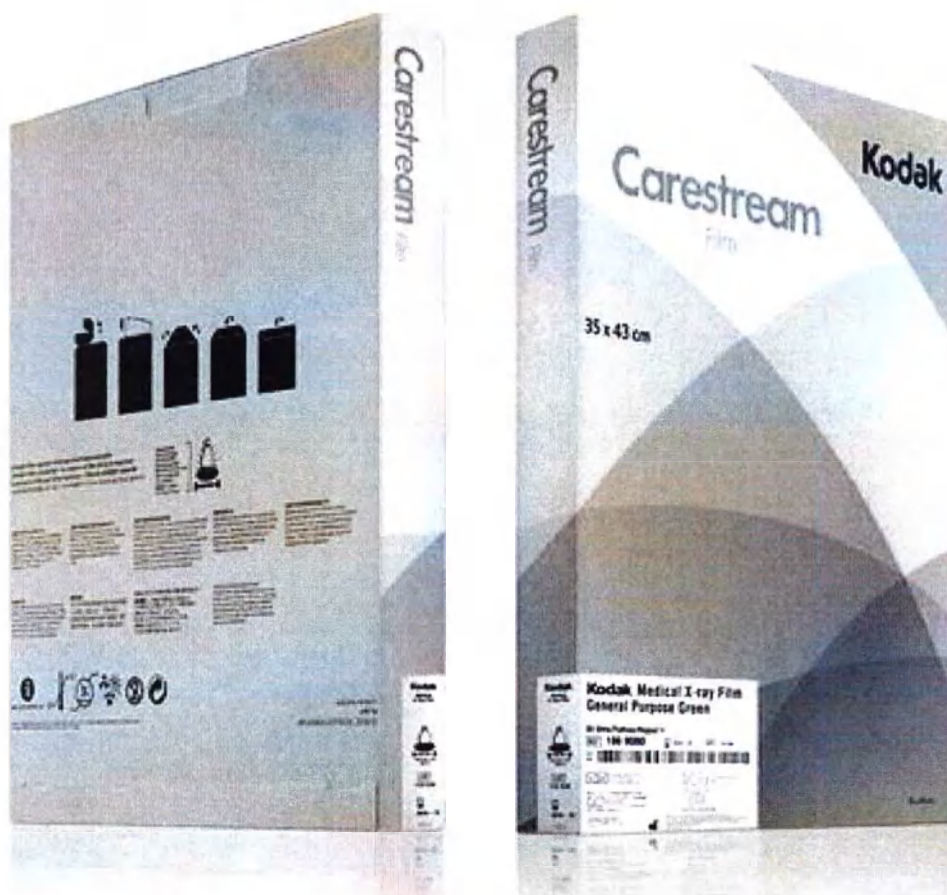

**Комплект рентгеновской пленки, производства фирмы
Carestream Health Inc. (Kodak), США**

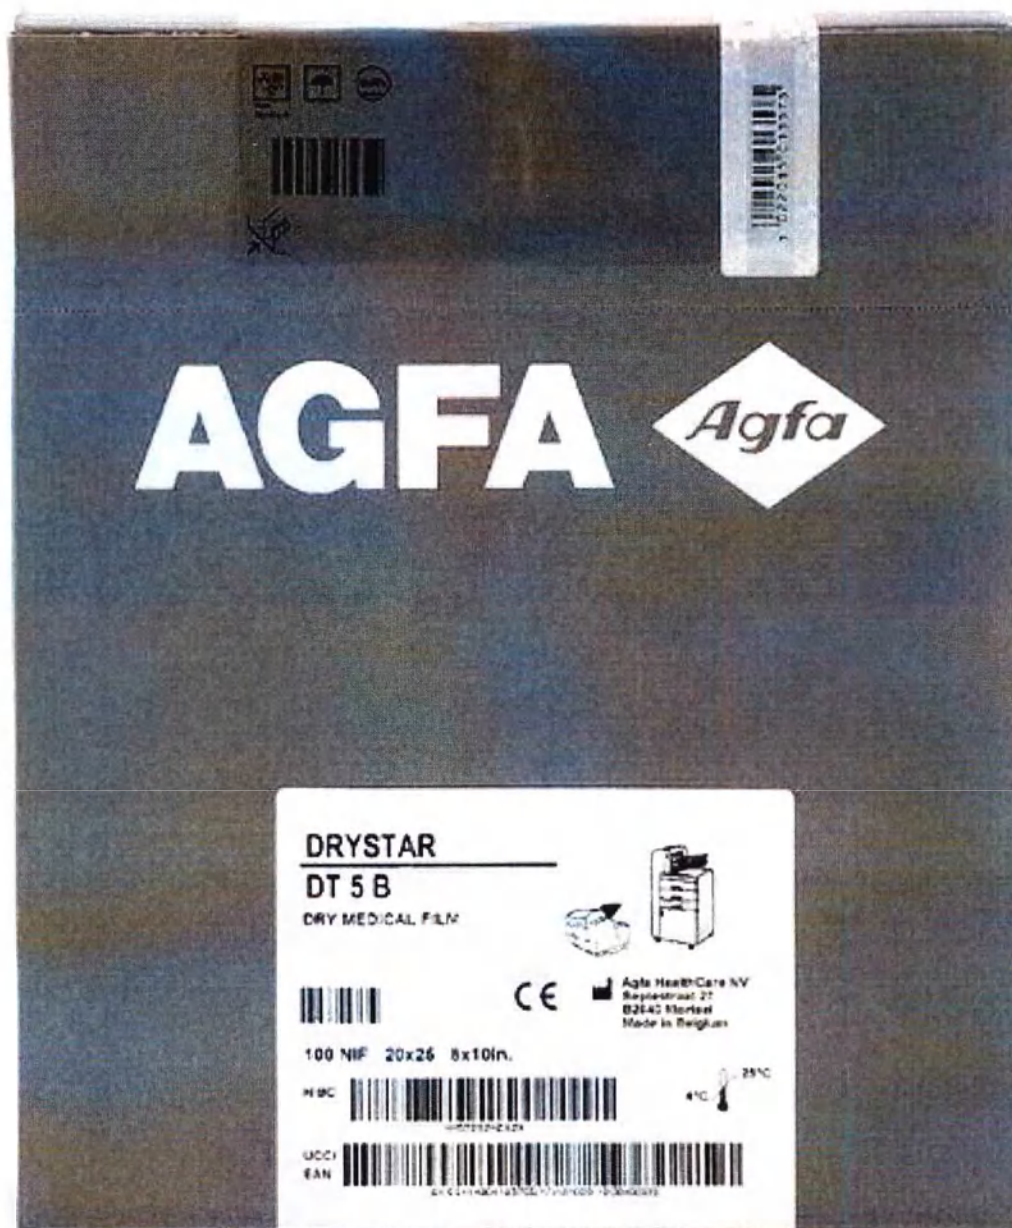

Комплект рентгеновской пленки, производства фирмы Agfa
N.V., Бельгия

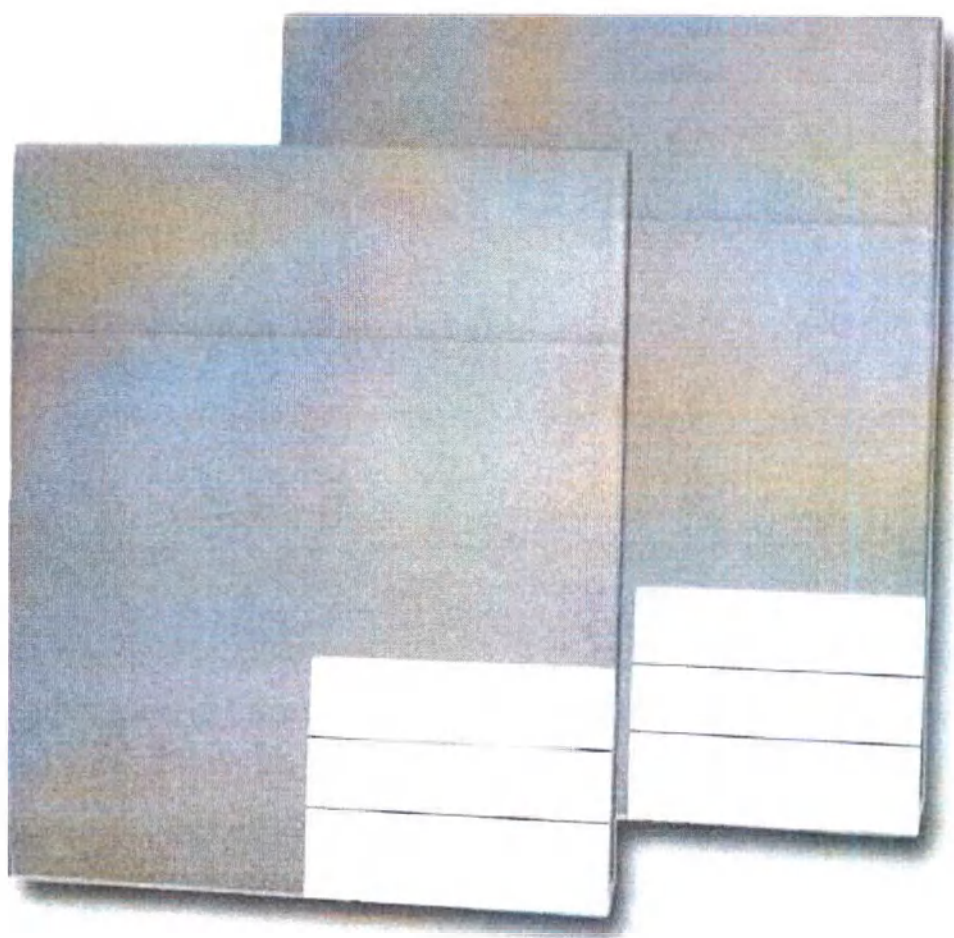

**Комплект рентгеновской пленки, производства фирмы АО
«МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия**



**Комплект рентгеновской одежды для пациентов и персонала
производства фирмы ООО «Рентген-Комплект», Россия, или
производства фирмы «Малое предприятие научно-
производственная фирма «ГАММАМЕД-П», Россия, или
производства фирмы ЗАО «РЕНЕКС», Россия**

На фото представлен комплект производства фирмы ЗАО
«РЕНЕКС»




**Фотографии упаковки и макета
маркировки медицинского изделия
«Аппарат рентгенографический
палатный передвижной «МобиРен-5-МТ»,
производства АО «МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ Лтд», Россия**

Макет маркировки изделия

АО «МТЛ»	
Аппарат рентгенографический палатный передвижной «МобиРен-5-МТ»	
Исполнение	«МобиРен-5-МТ»-_____
Зав. номер	МБР- _____
ТУ	9442-031-47245915-2010
Дата выпуска	_____ 20__ г.
Потребляемая мощность: _____ кВА Питание: 220 В 50 Гц Выходная мощность: _____ кВт Класс I 	
Сделано в России	

Номер и дата выдачи регистрационного удостоверения наносится методом стикерования.



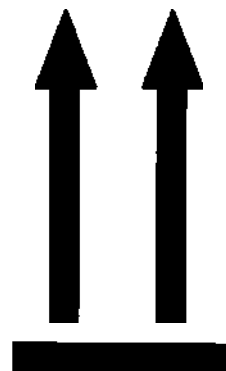

**Аппарат рентгенографический
палатный передвижной
«МобиРен-5-МТ»**

Заводской номер:

Год и месяц упаковывания:

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью _____ листов
Генеральный директор
Общество с ограниченной ответственностью
"Медицинские Технологии Лтд" А.Б. Эйлазов

