

Фотографические изображения изделия
Аппарат для вакуумной упаковки биологических образцов ТишьЮСЕЙФ плюс (TissueSAFE plus) в вариантах исполнения, с принадлежностями



Фото 1.1. Общий вид аппарата «Аппарат для вакуумной упаковки биологических образцов ТишьЮСЕЙФ плюс (TissueSAFE plus) в вариантах исполнения, с принадлежностями»



Фото 1.2. Общий вид аппарата с открытой крышкой в варианте исполнения «Аппарат для вакуумной упаковки биологических образцов ТишьюСЕЙФ плюс (TissueSAFE plus) базовый»



Фото 1.3. Вид аппарата сбоку в варианте исполнения «Аппарат для вакуумной упаковки биологических образцов ТишьюСЕЙФ плюс (TissueSAFE plus) базовый»



Фото 1.4. Вид аппарата сбоку в варианте исполнения «Аппарат для вакуумной упаковки биологических образцов ТишьюСЕЙФ плюс (TissueSAFE plus) базовый»



Фото 1.5. Вид аппарата сзади в варианте исполнения «Аппарат для вакуумной упаковки биологических образцов ТишьюСЕЙФ плюс (TissueSAFE plus) базовый»



MILESTONE
PATENTED

Аппарат для вакуумной упаковки биологических образцов ТишьюСЕЙФ
плюс (TissueSAFE plus) в вариантах исполнения,
с принадлежностями

Аппарат для вакуумной упаковки биологических образцов ТишьюСЕЙФ
плюс (TissueSAFE plus) базовый

REF 68900 SERIAL NUMBER (SN) 12346789

Параметры сети U=220 В~ +10%, 50 Гц
Рmax не более 1800 ВА



Декабрь 2021



«Майлстоун С.р.л.», Италия («Milestone S.r.l.», Italy)
Адрес: Виа Фатебенефрателли, 1/5, IT-24010 Соризоле (БГ), Италия
[Via Fatebenefratelli, 1/5, IT-24010 Sorisole (BG), Italy]

Место производства: «Майлстоун С.р.л.», Италия («Milestone S.r.l.», Italy)
Корсо Европа Унита, 6, IT-24030 Вальбрембо (БГ), Италия
[Corso Europa Unità, 6, IT-24030 Valbrembo (BG), Italy]

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «БиоЛайн»
Почтовый адрес: 197022, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова д.23, лит. Е
Тел.: 8(812)320-49-49, 8 800 555 49 46



MILESTONE SRL

Via Fatebenefratelli, 1/5 - 24010 Sorisole (BG) - ITALY
Tel. +39.035.4128264 Fax. +39.035.575498



TISSUESAFE PLUS

REF 68900

SERIAL NUMBER SN 12346789

INPUT: 230V~ 50Hz 1500W, PEAK POWER 1800Wp

MANUFACTURED: DECEMBER 2021



(01)08052478981307(21)203707219(240)68902

Фото 1.6. Шильда производителя для аппарата в варианте исполнения «Аппарат для вакуумной упаковки биологических образцов ТишьюСЕЙФ плюс (TissueSAFE plus) базовый»



Фото 2.1. Вид аппарата сверху с открытой крышкой в варианте исполнения «Аппарат для вакуумной упаковки биологических образцов ТишьюСЕЙФ плюс WDLR (TissueSAFE plus WDLR) со встроенным разъёмом для устройства считывания и контроля температуры»



Фото 2.2. Вид аппарата сзади в варианте исполнения «Аппарат для вакуумной упаковки биологических образцов ТишьюСЕЙФ плюс WDLR (TissueSAFE plus WDLR) со встроенным разъёмом для устройства считывания и контроля температуры»



MILESTONE
LIVING
PATIENTS

Аппарат для вакуумной упаковки биологических образцов ТишьюСЕЙФ
плюс (TissueSAFE plus) в вариантах исполнения,
с принадлежностями

Аппарат для вакуумной упаковки биологических образцов ТишьюСЕЙФ
плюс WDLR (TissueSAFE plus WDLR) со встроенным разъёмом для
устройства считывания и контроля температуры

REF 68902 SERIAL NUMBER (SN) 203707219

Параметры сети: U=220 В~ +10%, 50 Гц

Pmax: не более 1800 ВА



Сентябрь 2020



«Майлстоун С.р.л.», Италия («Milestone S.r.l.», Italy)

Адрес: Виа Фатебенефрателли, 1/5, IT-24010 Соризола (БГ), Италия
(Via Fatebenefratelli, 1/5, IT-24010 Sorisole (BG), Italy)

Место производства: «Майлстоун С.р.л.», Италия («Milestone S.r.l.», Italy)

Корпо Европа Унита, 6, IT-24030 Вальбрембо (БГ), Италия


(Corso Europa Unità, 6, IT-24030 Valbrembo (BG), Italy)

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Биолайн»

Почтовый адрес: 197022, Россия, г. Санкт-Петербург,

ул. Профессора Попова, д. 23, лит. Е

Тел.: 8(812)320-49-49, 8 800 555 49 40



MILESTONE SRL

Via Fatebenefratelli, 1/5 - 24010 Sorisole (BG) - ITALY
Tel: +39.035.4128264 Fax: +39.035.676498



TISSUESAFE PLUS WDLR

REF 68902

SERIAL NUMBER SN 203707219

INPUT: 230V~ 50Hz 1500W, PEAK POWER 1800Wp

MANUFACTURED: SEPTEMBER 2020



VD130405347898130721120370721910240152020

Фото 2.3. Шильда производителя для аппарата в варианте исполнения «Аппарат для вакуумной упаковки биологических образцов ТишьюСЕЙФ плюс WDLR (TissueSAFE plus WDLR) со встроенным разъёмом для устройства считывания и контроля температуры»



Фото 2.4. Вид аппарата сбоку в варианте исполнения «Аппарат для вакуумной упаковки биологических образцов ТишьюСЕЙФ плюс WDLR (TissueSAFE plus WDLR) со встроенным разъёмом для устройства считывания и контроля температуры»



Фото 2.5. Вид аппарата сбоку в варианте исполнения «Аппарат для вакуумной упаковки биологических образцов ТишьюСЕЙФ плюс WDLR (TissueSAFE plus WDLR) со встроенным разъёмом для устройства считывания и контроля температуры»



Фото 3. Вытяжной шланг (Discharge tube)



Фото 4.1. Металлический хомут (Metal strap)



Фото 4.2. Металлический хомут (Metal strap)

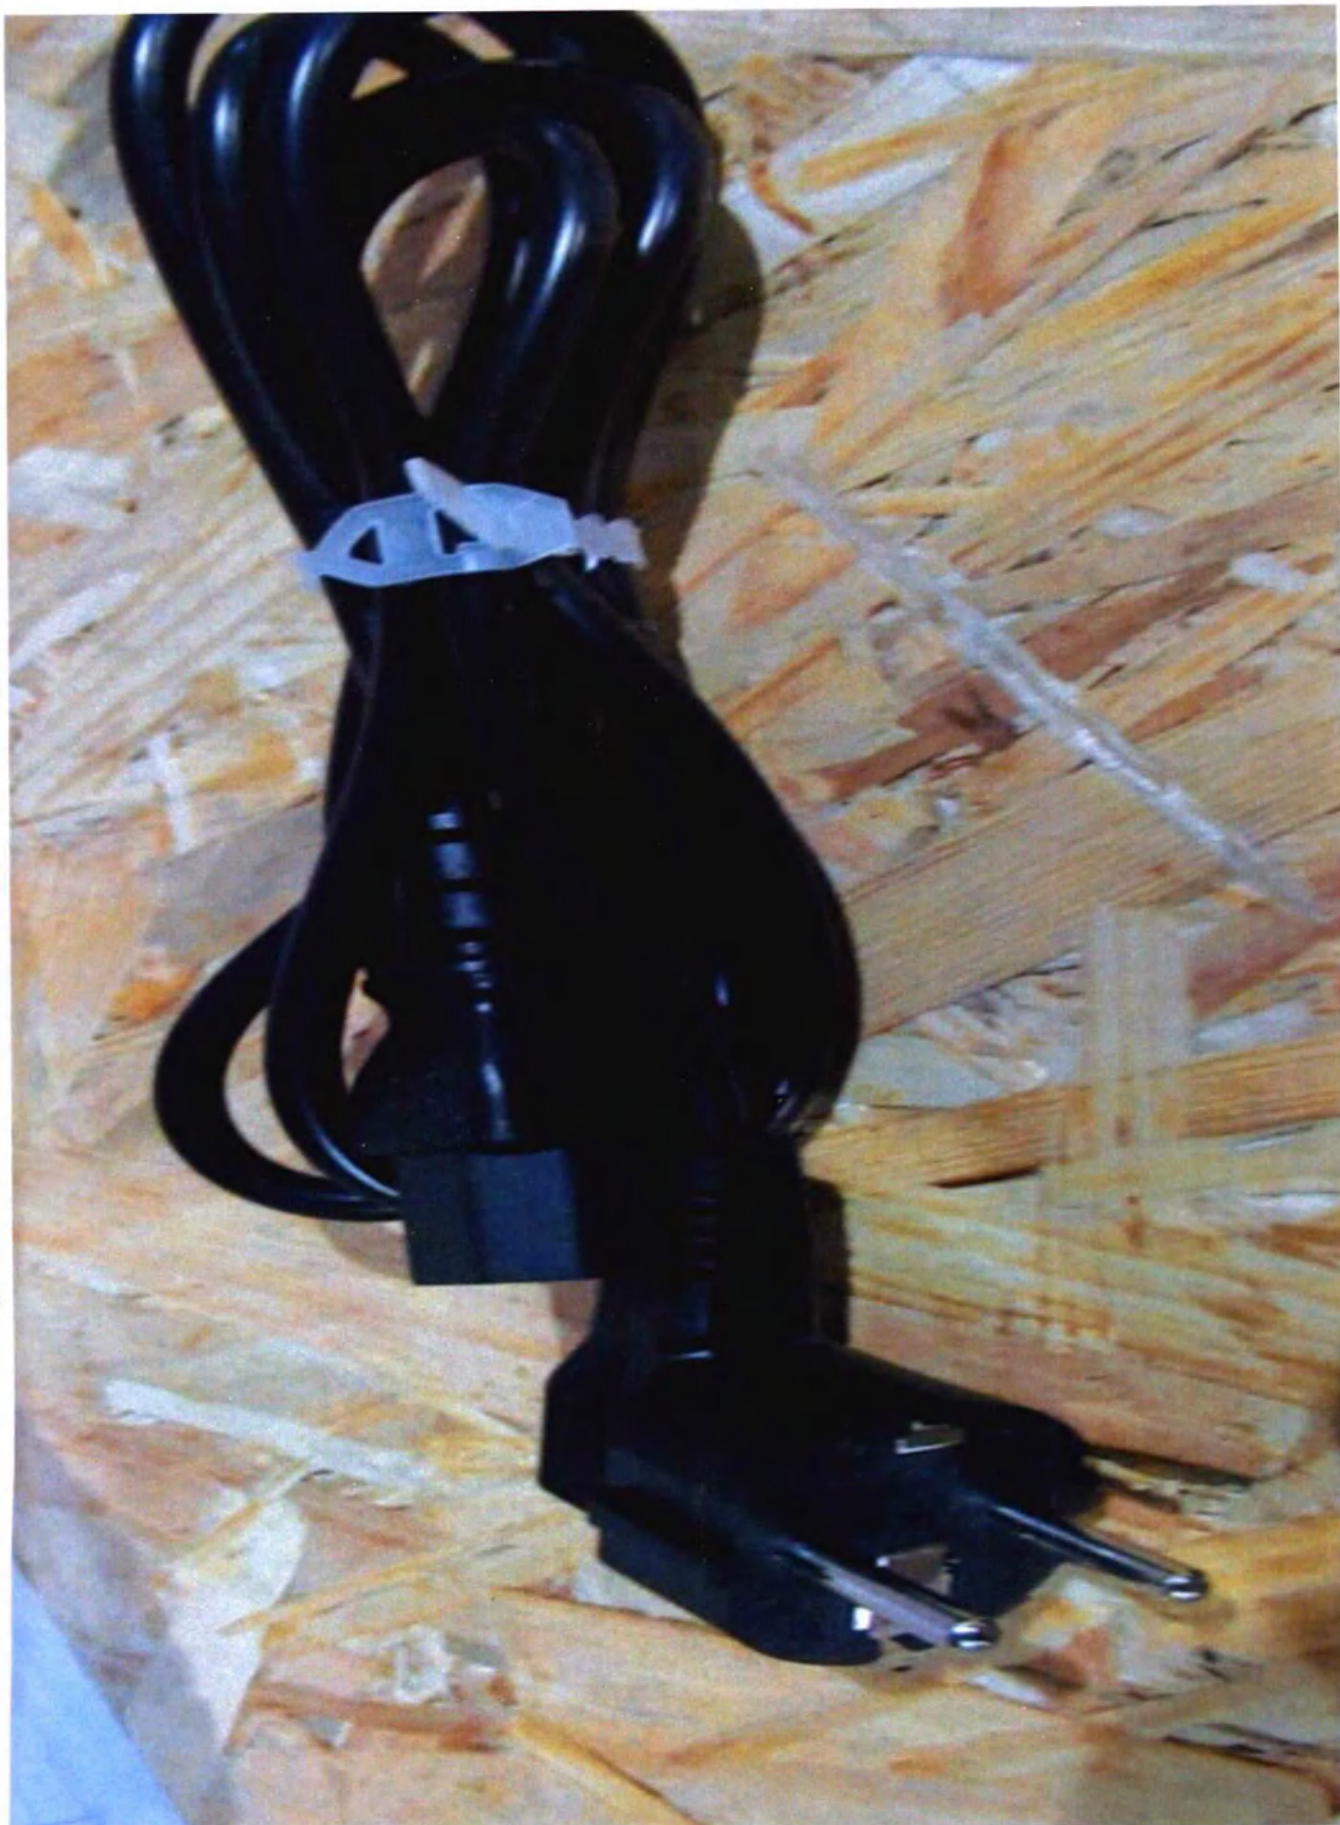


Фото 5.1. Сетевой кабель (Main power cable)

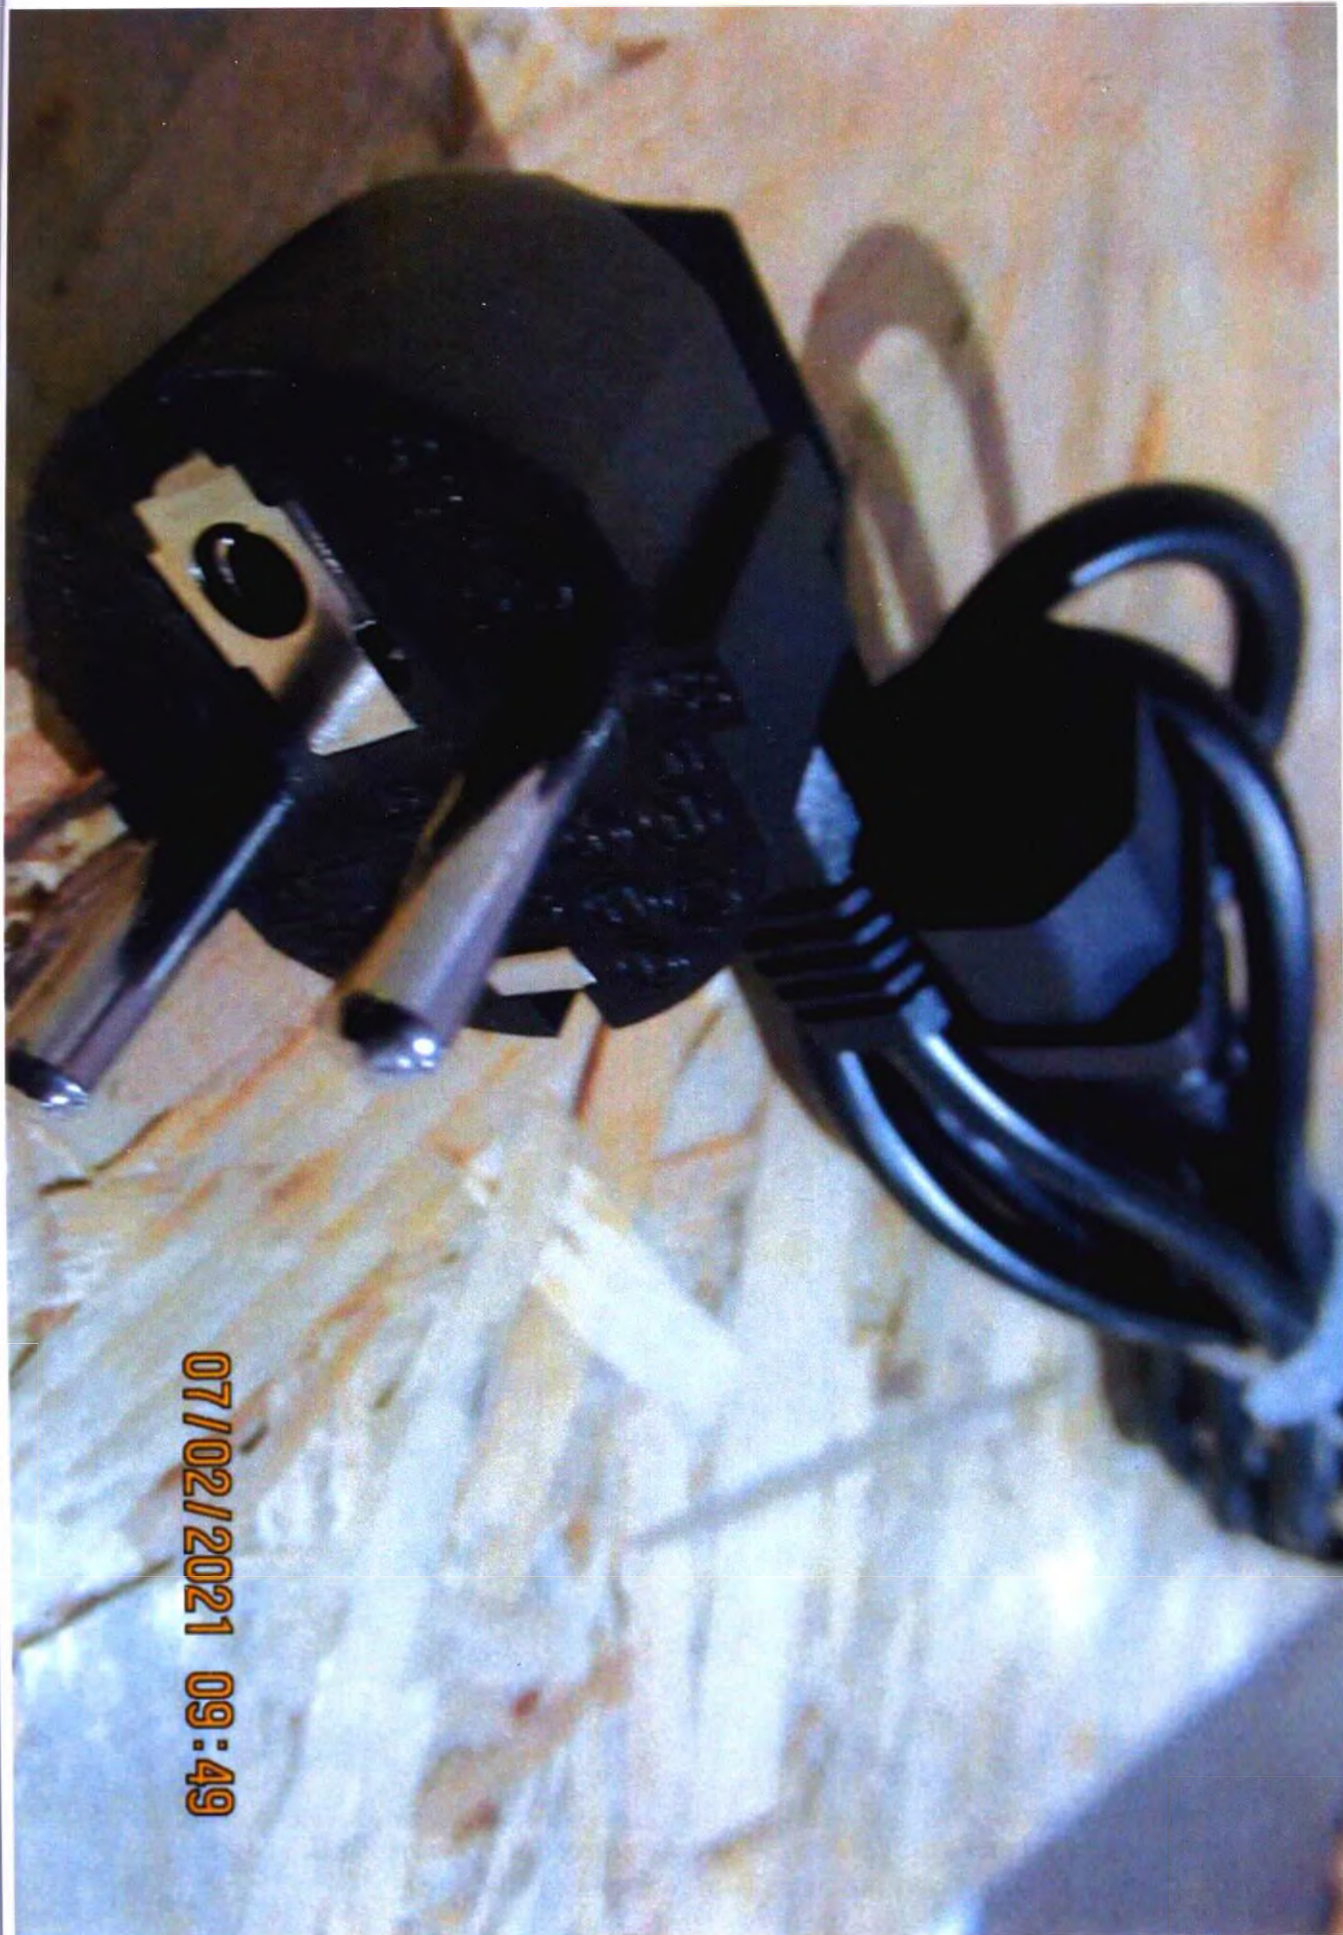



Фото 5.2. Сетевой кабель (Main power cable)



**Фото 6.1. Считыватель штрих-кодов, установленный на подставку
(Barcode reader mounted on its support)**



Фото 6.2. Считыватель штрих-кодов, установленный на подставку
(Barcode reader mounted on its support)

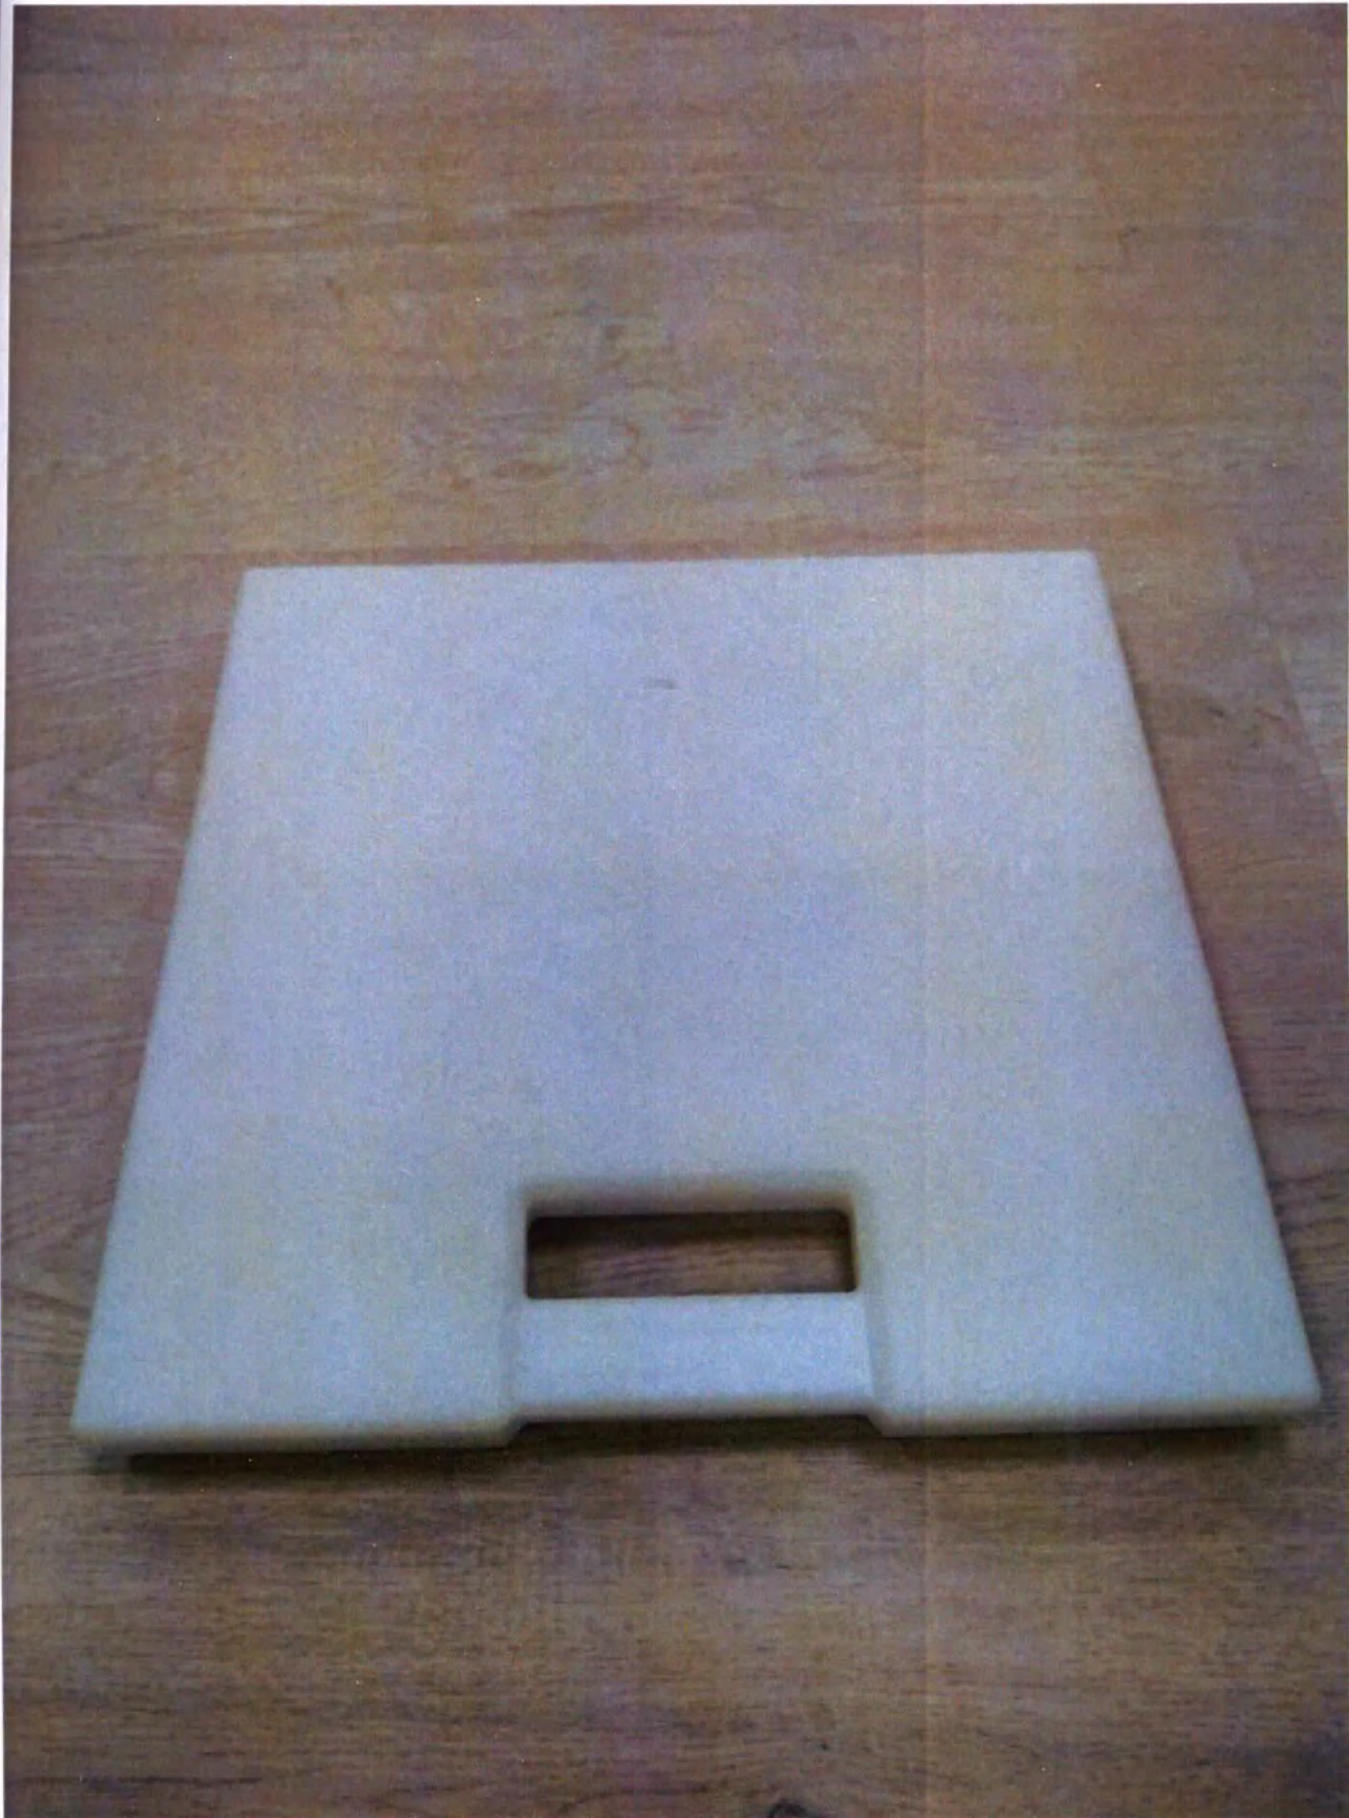

**Фото 7. Пластиковая вставка, установленная в камере
(Plastic spacers positioned in the cavity)**



Фото 8.1. Полка для вставки в держатель пакетов
(Shelves to be inserted into the holder for bags)



**Фото 8.2. Полка для вставки в держатель пакетов
(Shelves to be inserted into the holder for bags)**



Фото 9. USB-носитель с программным обеспечением «LogViewer»
(USB flash drive containing “LogViewer” software)


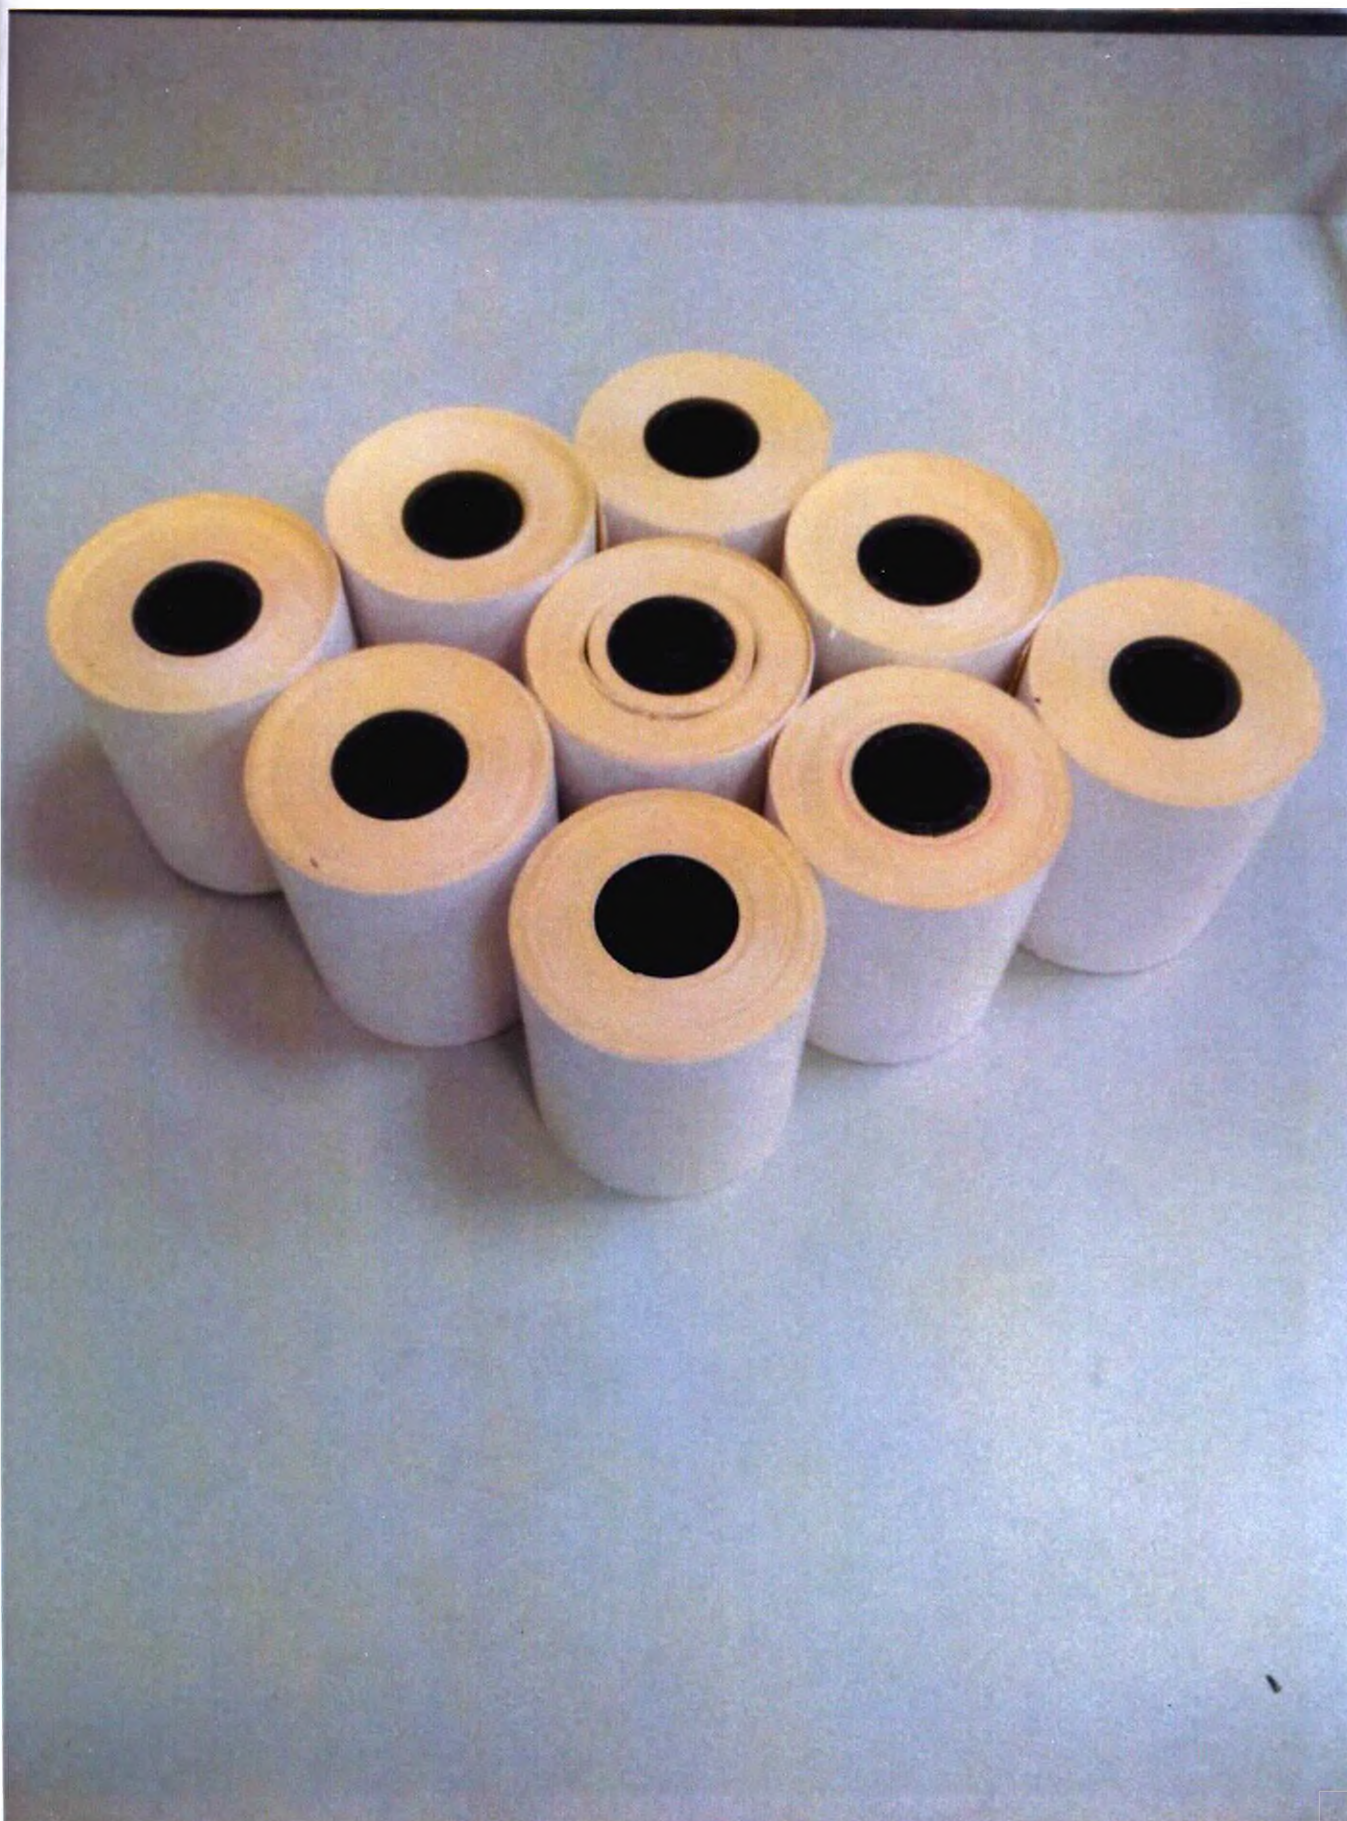


Фото 10. Рулон бумаги для принтера (Rolls of printer paper)

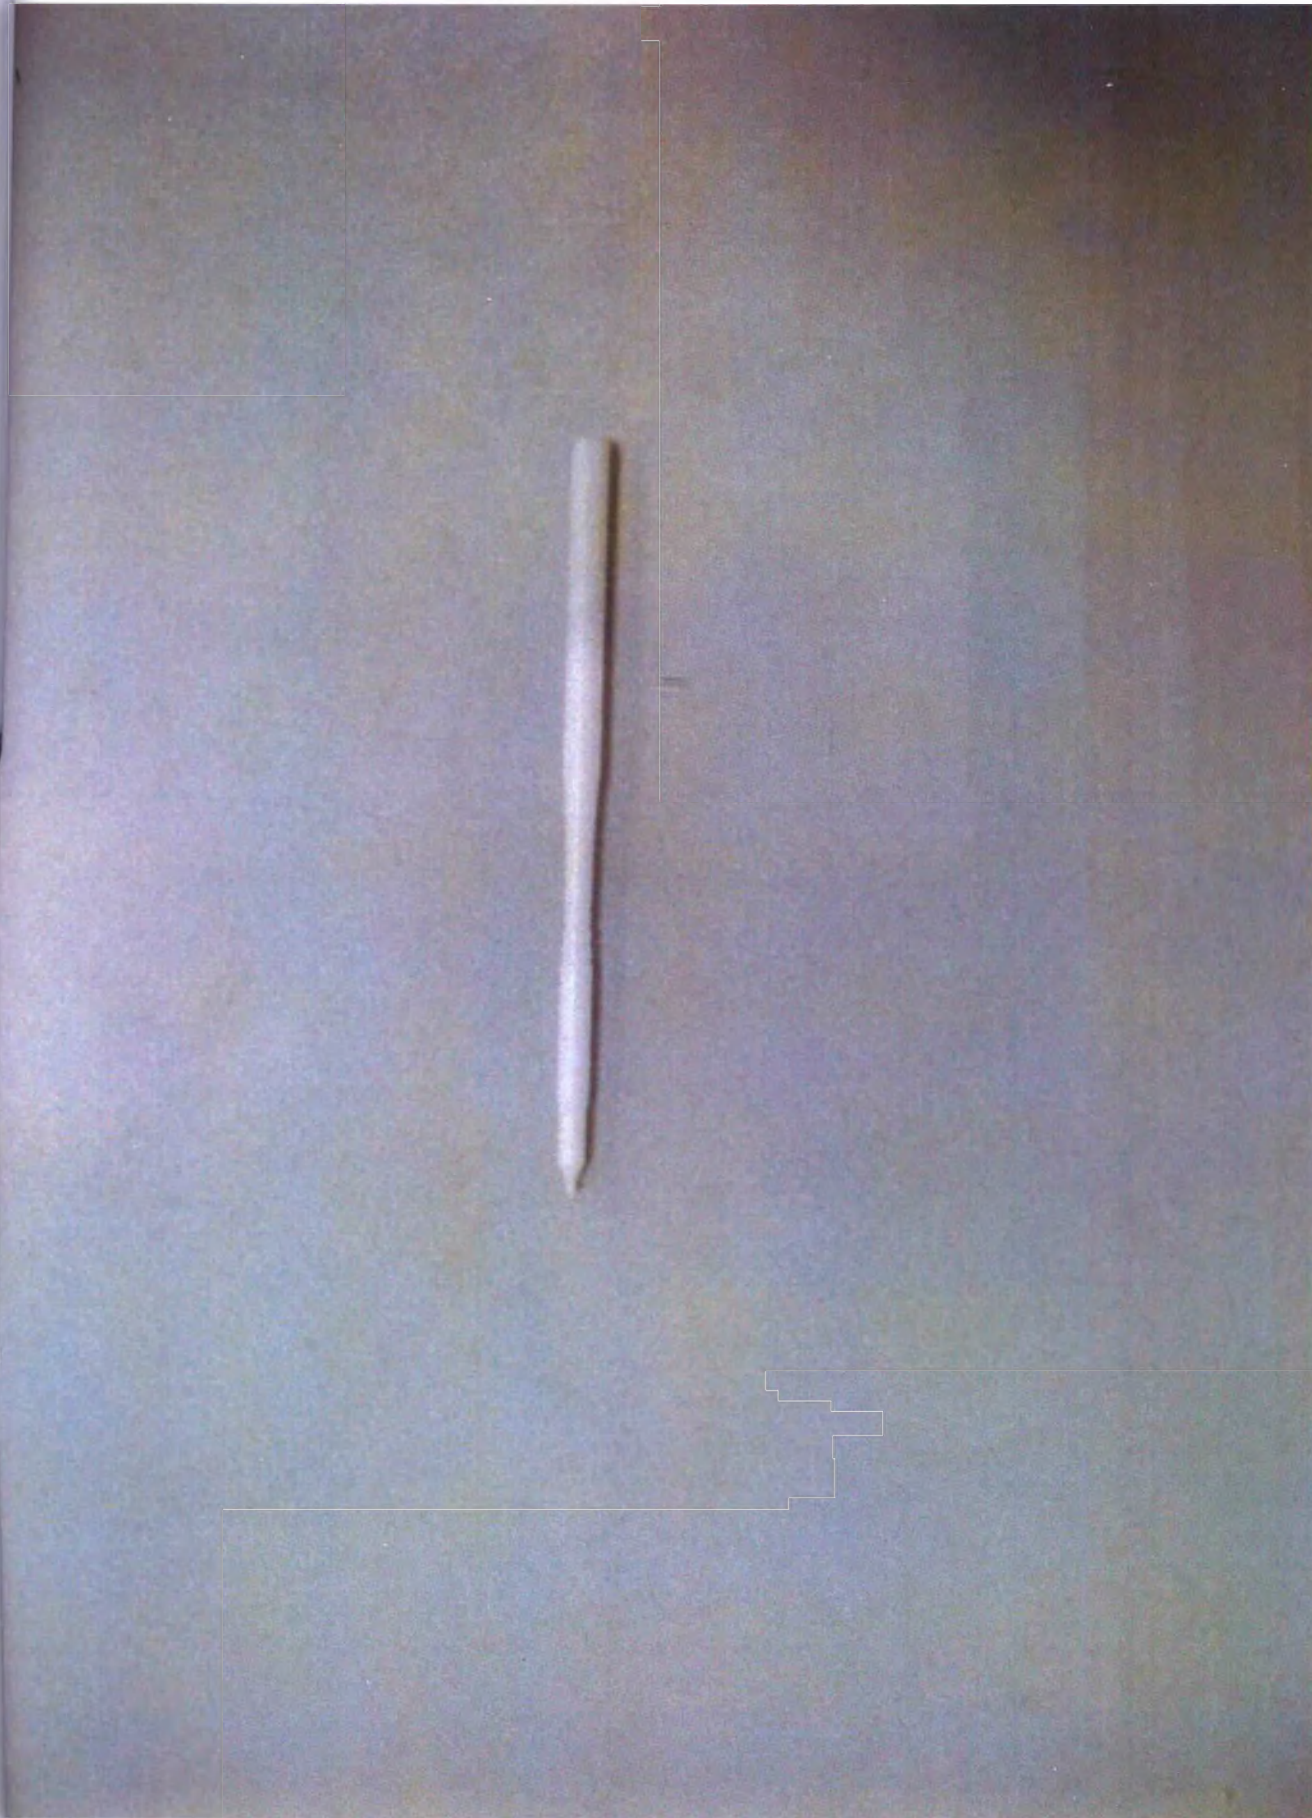

**Фото 11. Стилус для работы с сенсорной панелью
(Stylus for working with the touch screen terminal)**



Фото 12. Руководство по эксплуатации в электронном формате
(Operator Manual in electronic format)

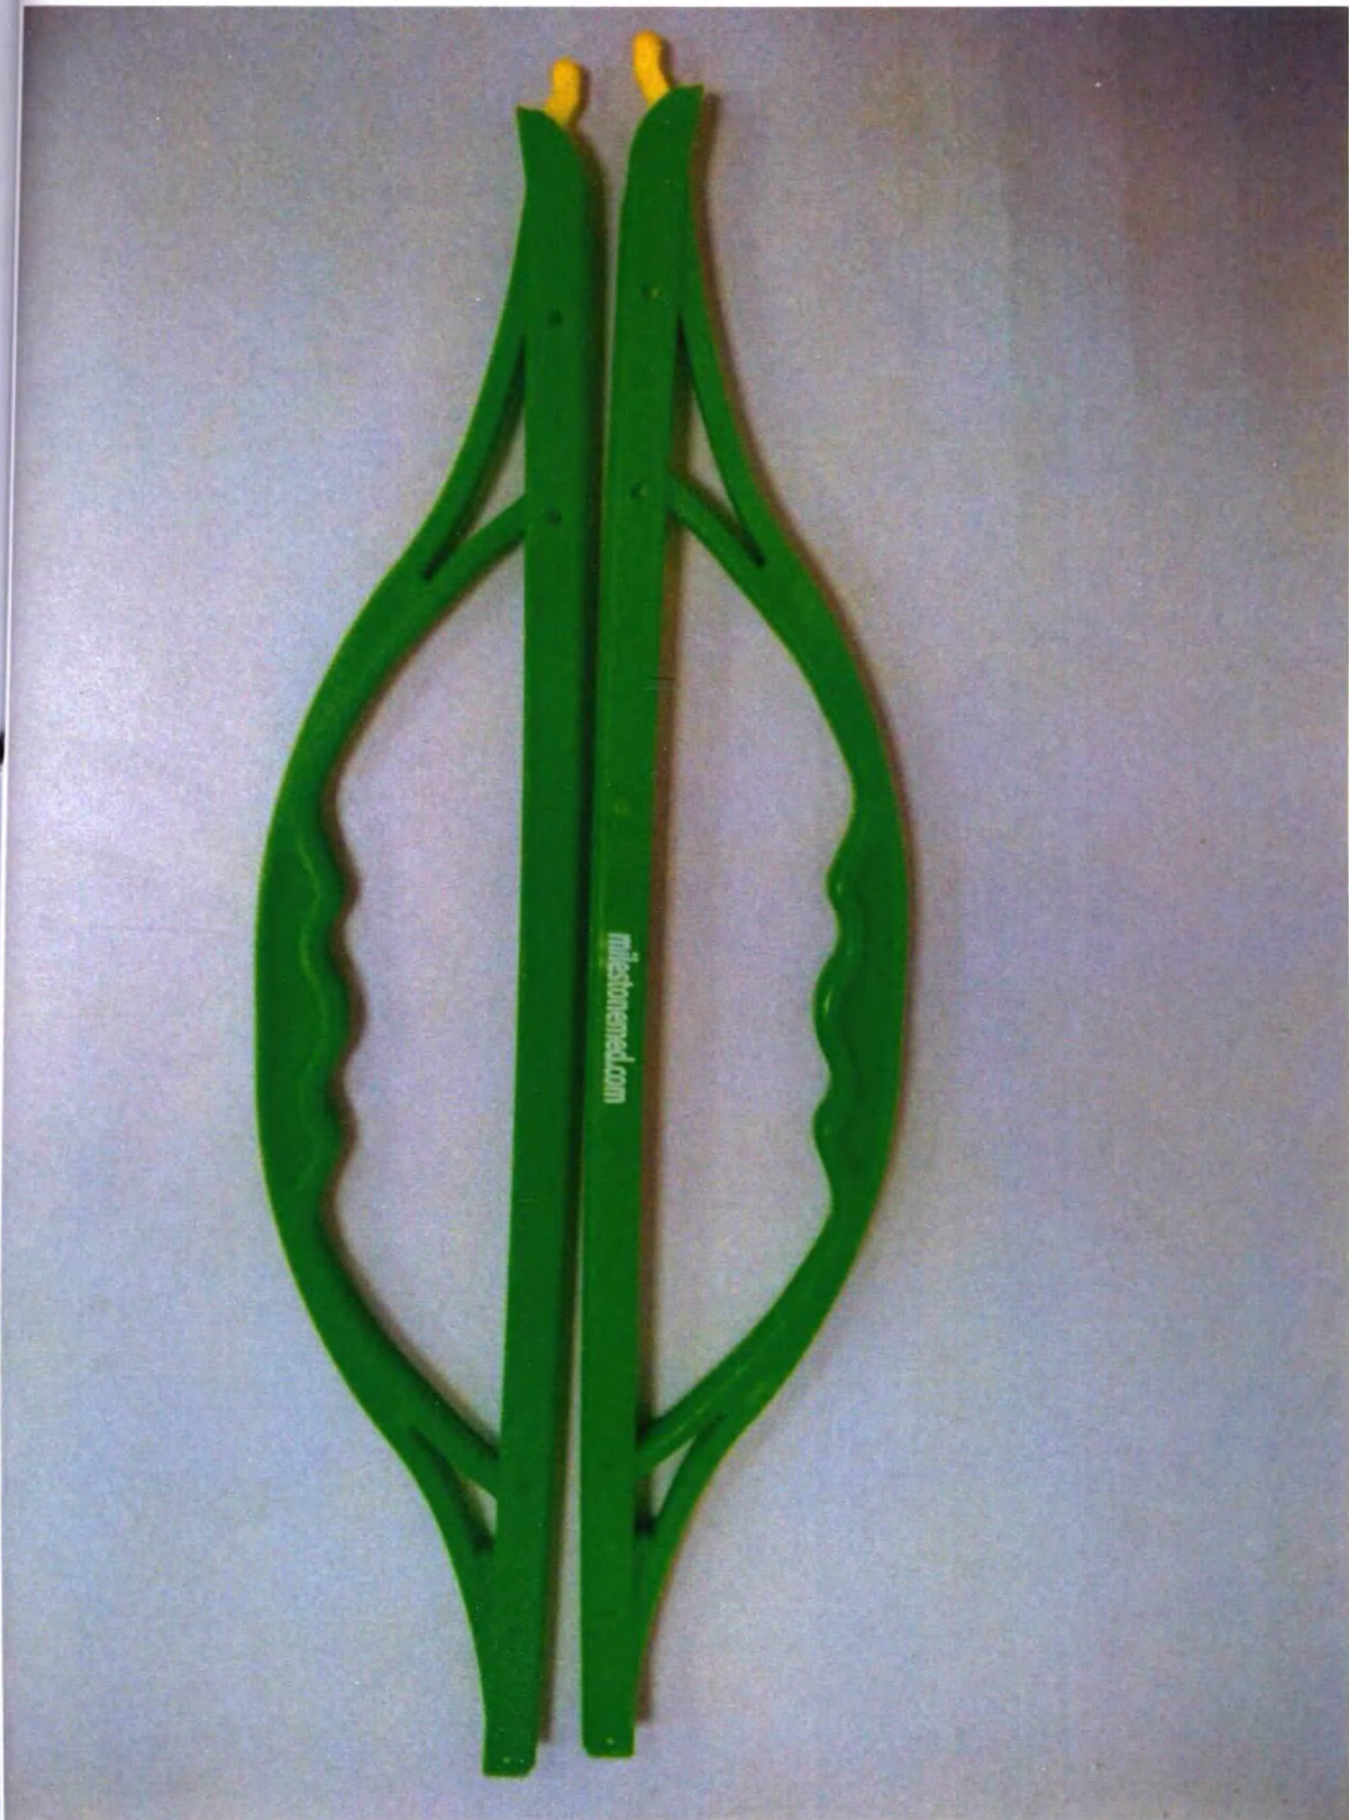


Фото 13. Зажим с ручкой для пакетов (Bag sealer with handle)



MILESTONE
H E L P I N G
P A T I E N T S



Аппарат для вакуумной упаковки биологических образцов ТишьюСЕЙФ плюс
(TissueSAFE plus) в вариантах исполнения, с принадлежностями

Руководство по эксплуатации – ММ123

**Фото 14. Руководство по эксплуатации в бумажном формате
(Operator Manual in paper format)**



**Фото 15.1. Изотермический контейнер объемом 32 литра с аккумуляторами холода (4 шт.)
(Kit Refrigerator box in PS, 32 liters complete with N.4 cool packs)**



Фото 15.2. Изотермический контейнер объемом 32 литра с аккумуляторами холода (4 шт.)
Refrigerator box in PS, 32 liters complete with N.4 cool packs) - внутренняя конструкция изотермического контейнера



Фото 16. Устройство для считывания и контроля температуры
(Temperature monitoring system)



Фото 16.1. HEPA фильтр (HEPA filter)



Фото 16.2. НЕРА фильтр (HEPA filter)

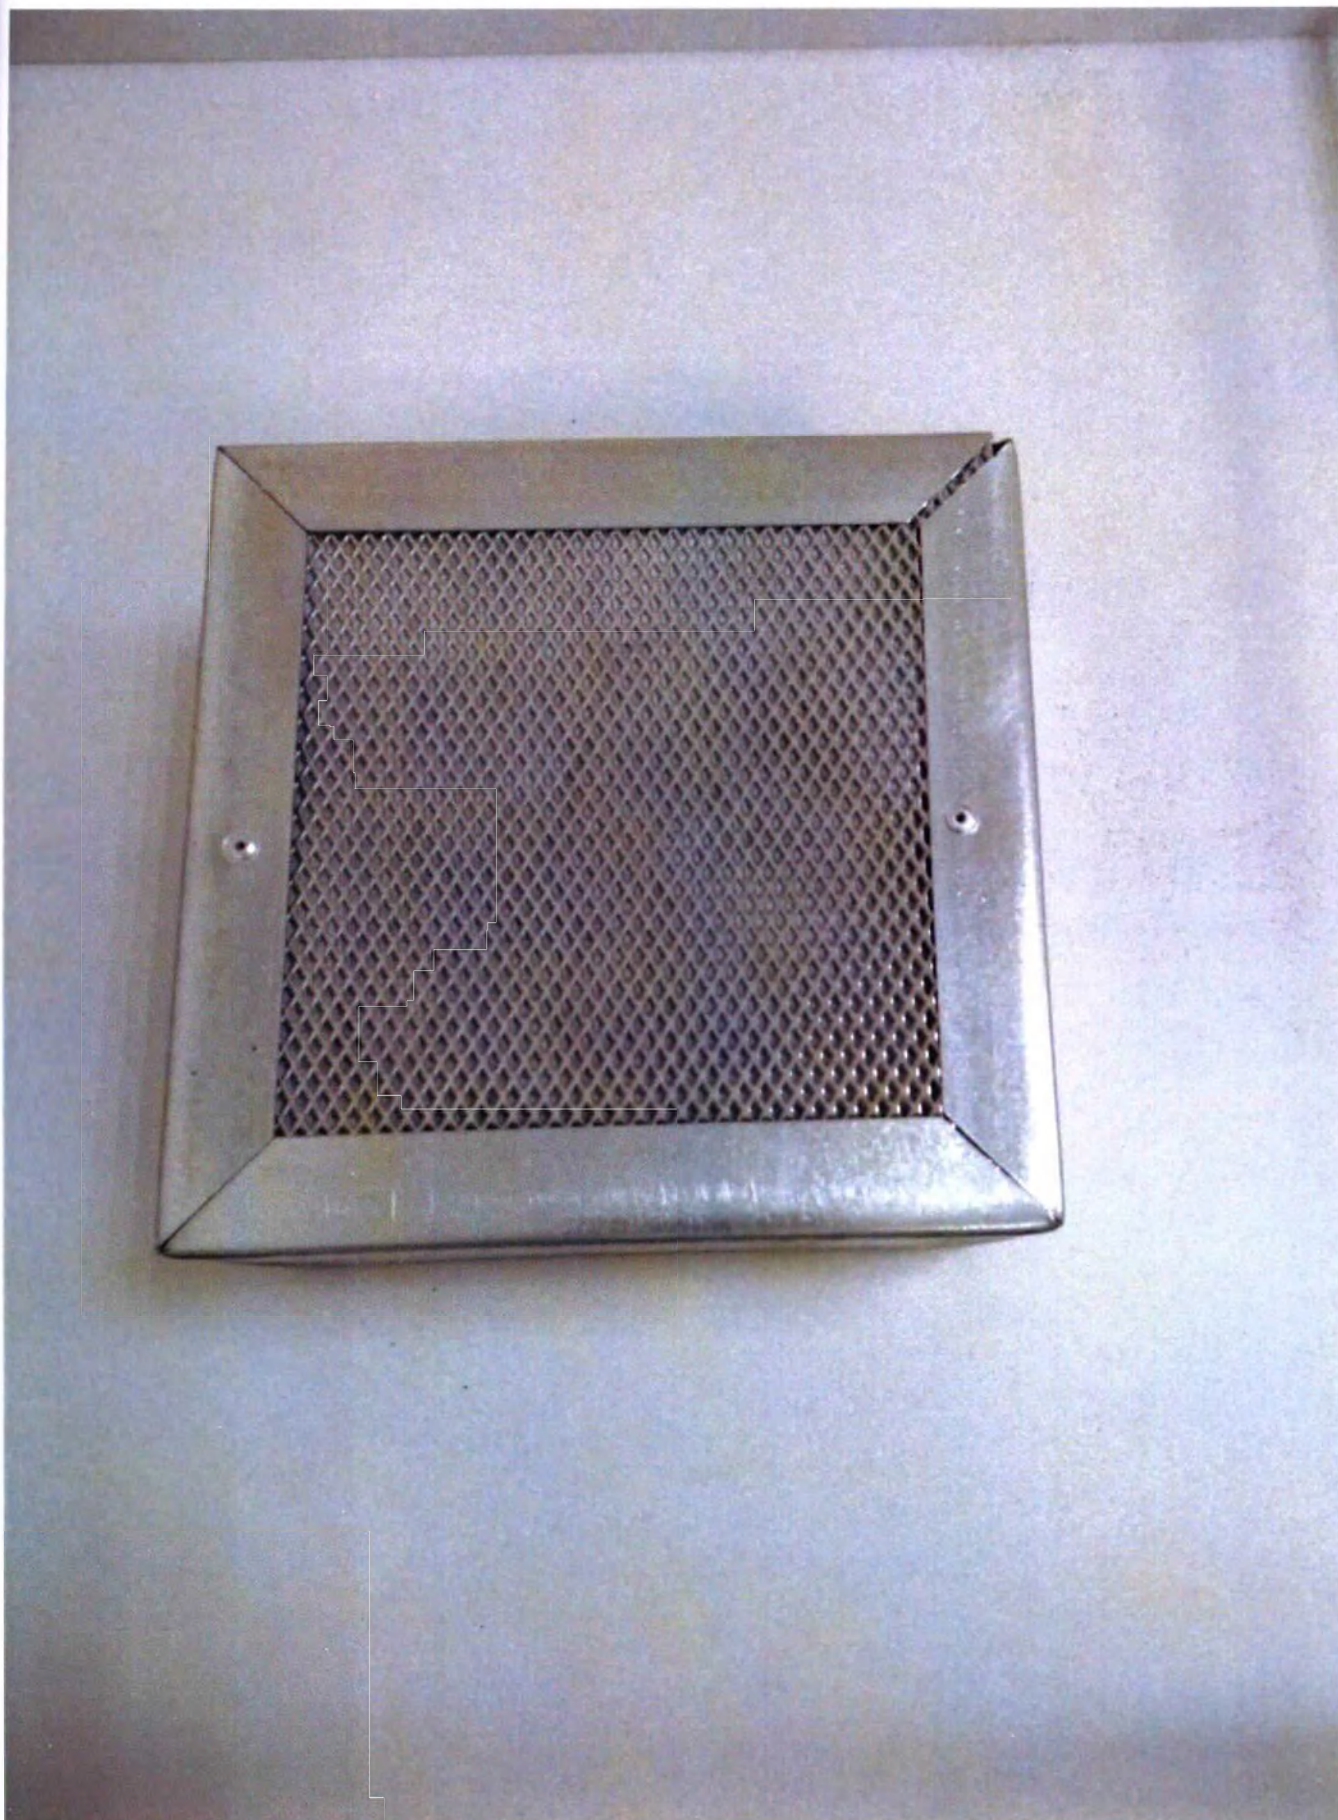


Фото 17.1. Угольный фильтр (Carbon filter)

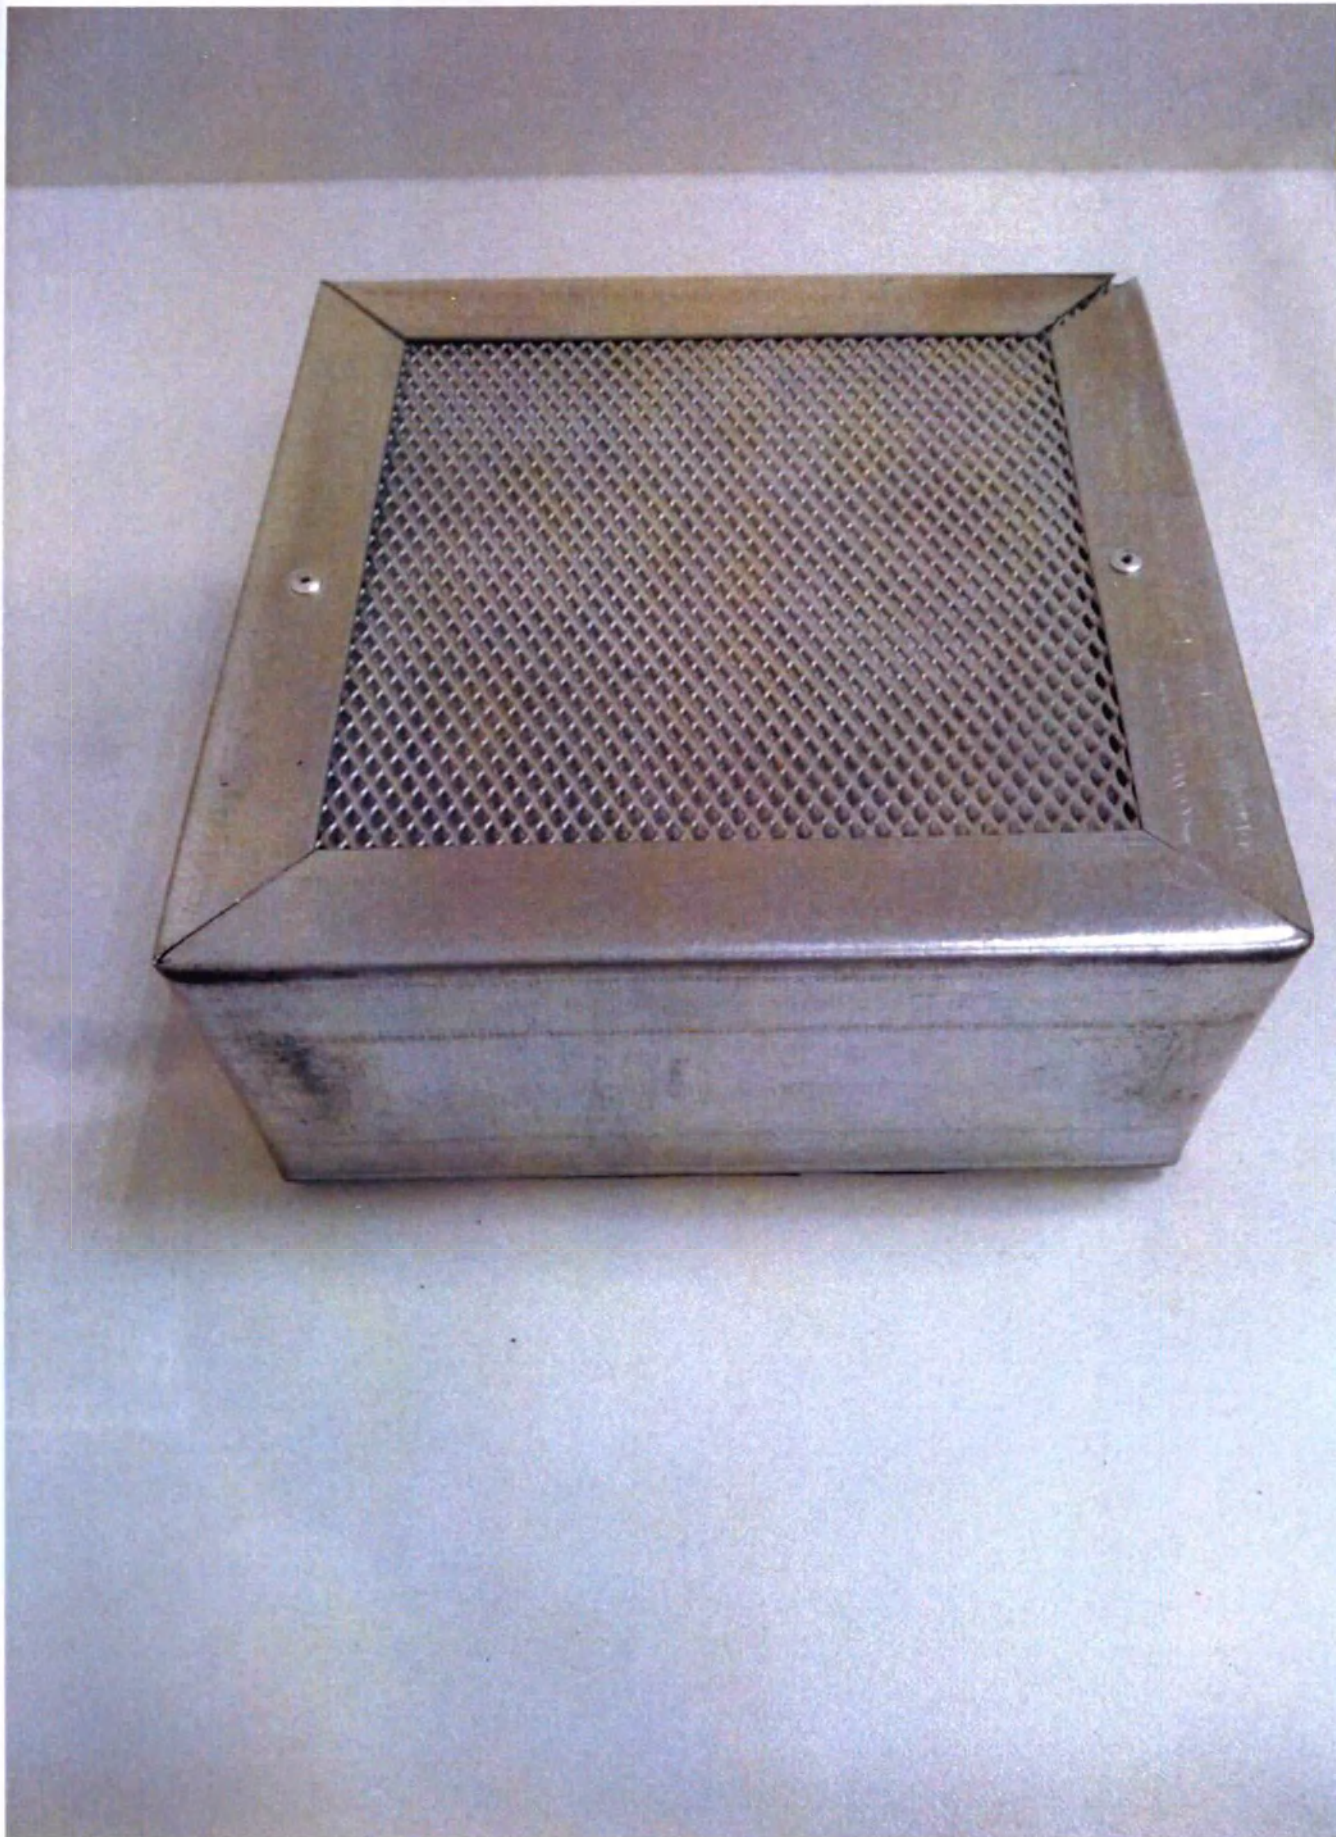


Фото 17.2. Угольный фильтр (Carbon filter)

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 24 листов

Директор по правовым вопросам

ООО «БиоЛайн»

Н.К. Гусева

