

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Кранц»

И.В. Кузьмина

« 27 » февраля 2019 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore

производства фирмы Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Китай

2019


- 2
1. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, 14 параметров (Аскорбиновая кислота, Глюкоза, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Удельный вес, Кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты, Альбумин, Креатинин, Кальций), (ASC, GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU, ALB, CRE, Ca) U031-141C



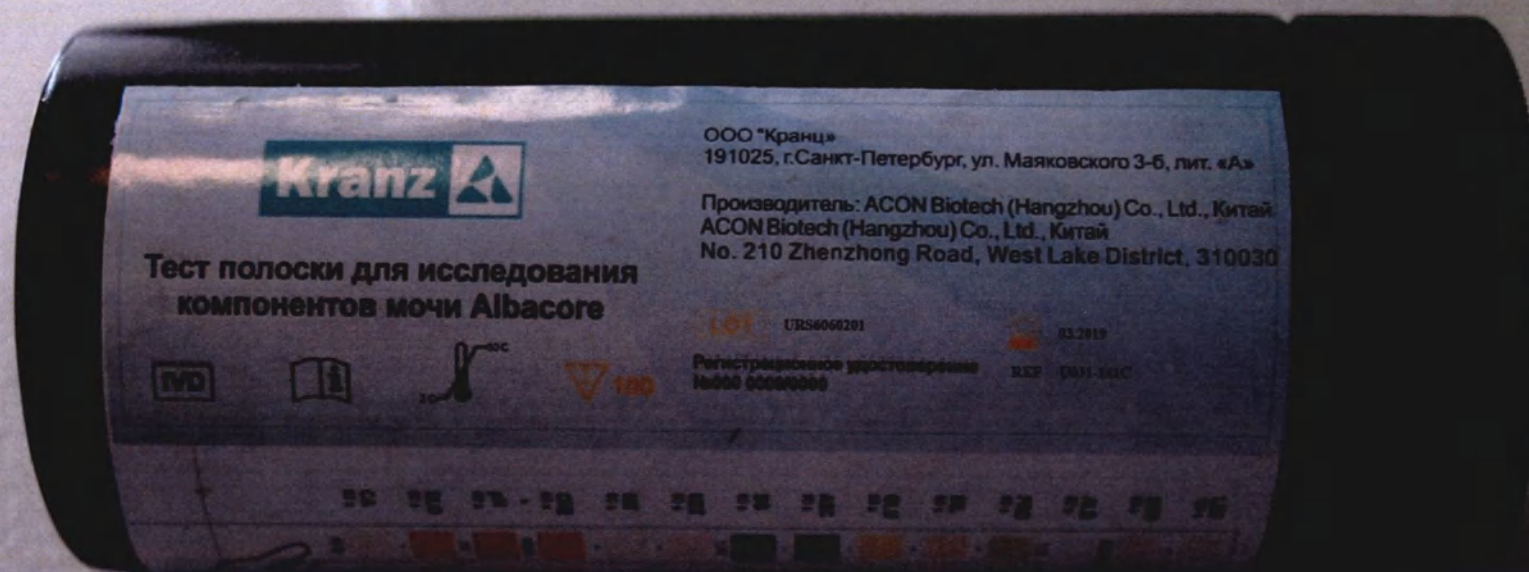


2. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albascore, 13 параметров (Аскорбиновая кислота, Глюкоза, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Удельный вес, Кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты, Альбумин, Креатинин) (ASC, GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU, ALB, CRE) U031-131CE



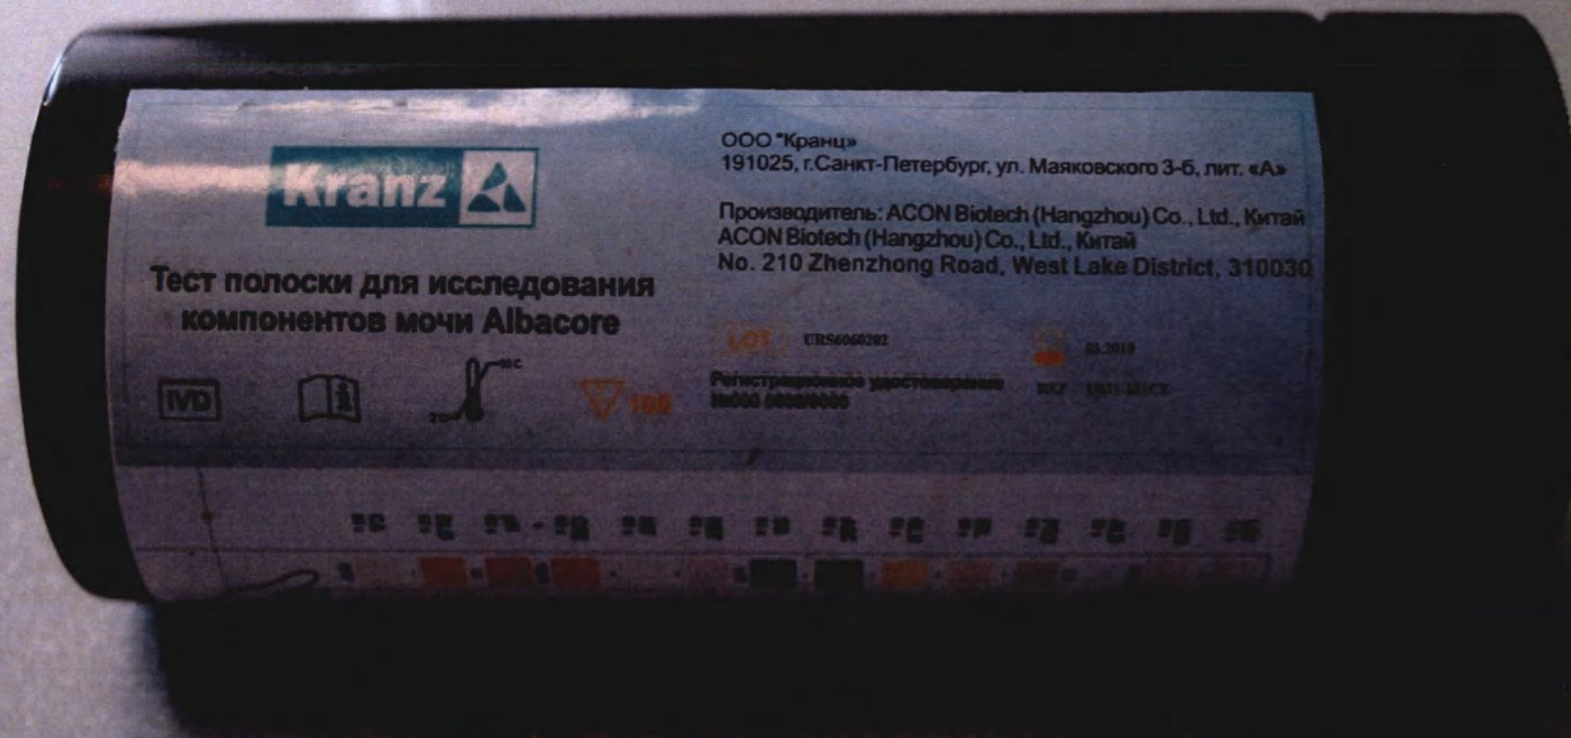


3. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albascore, 11 параметров (Аскорбиновая кислота, Глюкоза, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Удельный вес, Кровь, рН, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты) (ASC, GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU) U031-111A



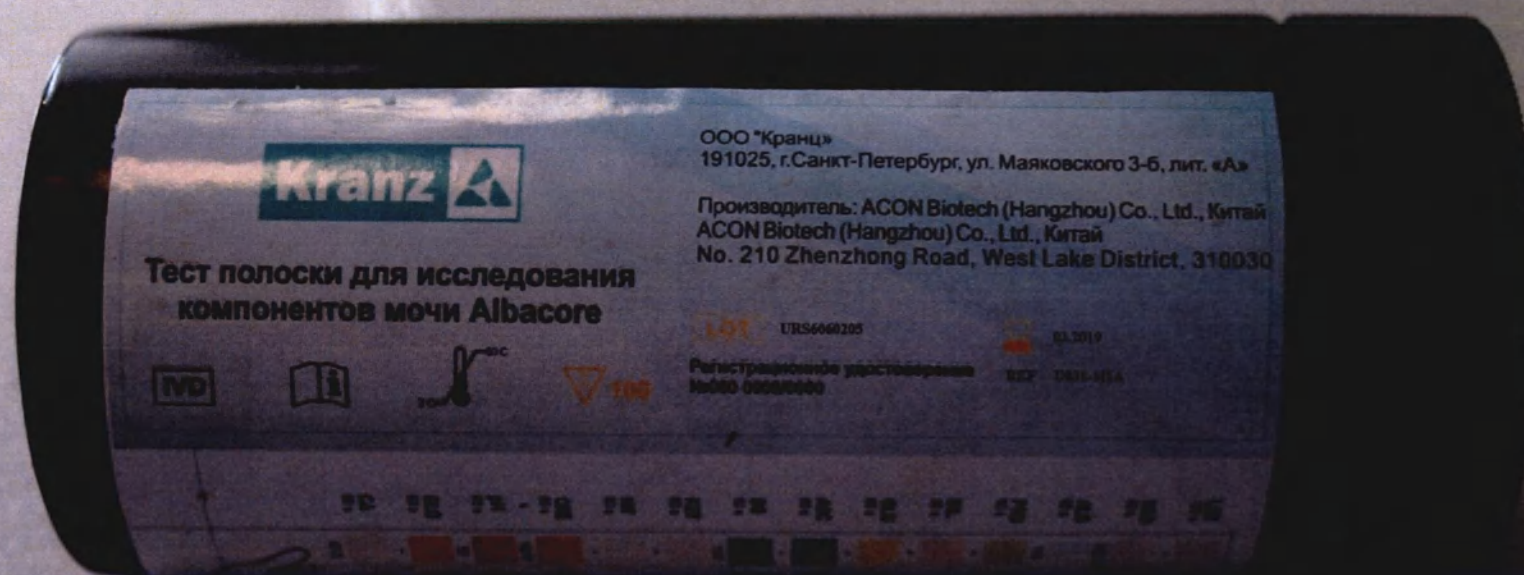


4. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, 11 параметров (Глюкоза, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Удельный вес, Кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты, Альбумин) (GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU, ALB) U031-112A



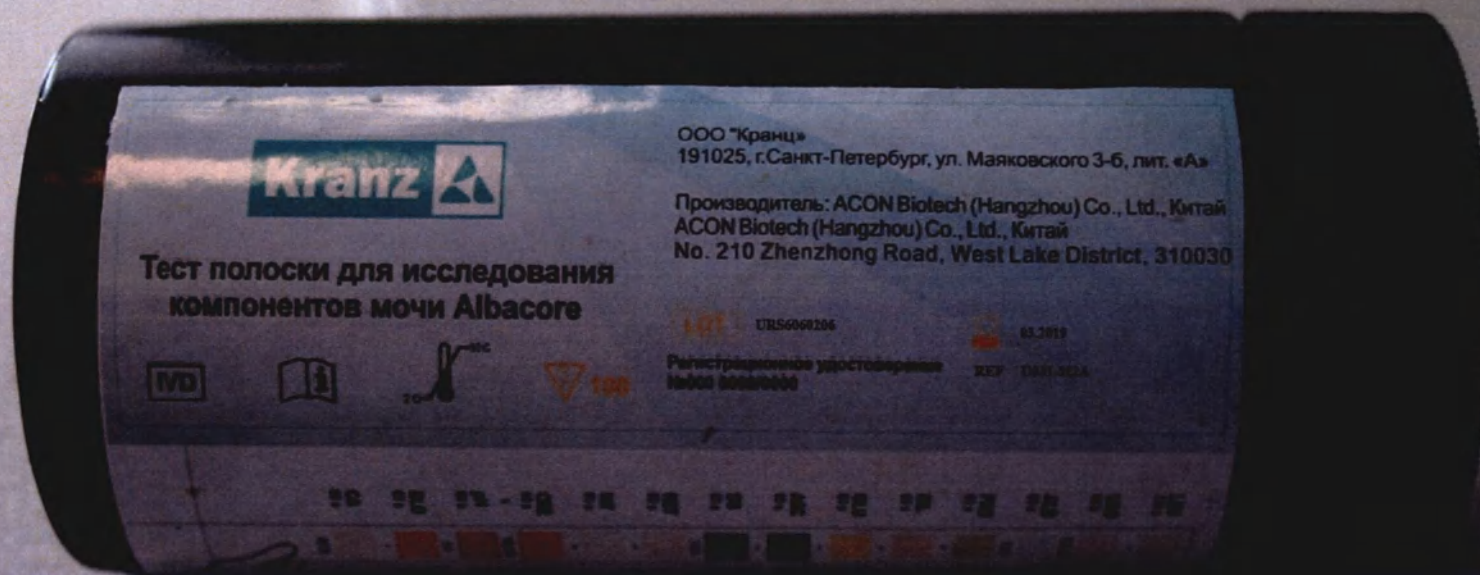


5. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, 10 параметров (Глюкоза, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Удельный вес, Кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты) (GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU) U031-101U



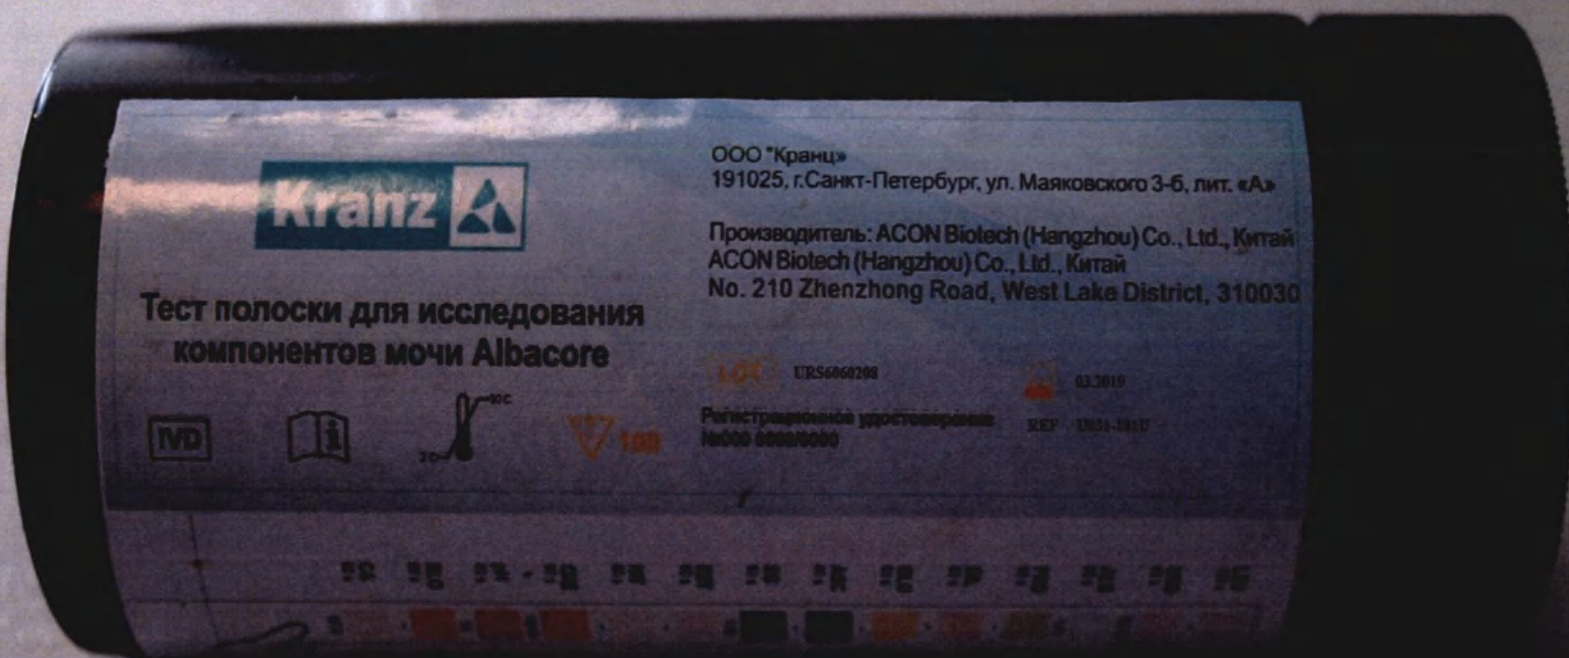


6. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albascore, 9 параметров (Глюкоза, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Удельный вес, Кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты) (GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT) U031-091U



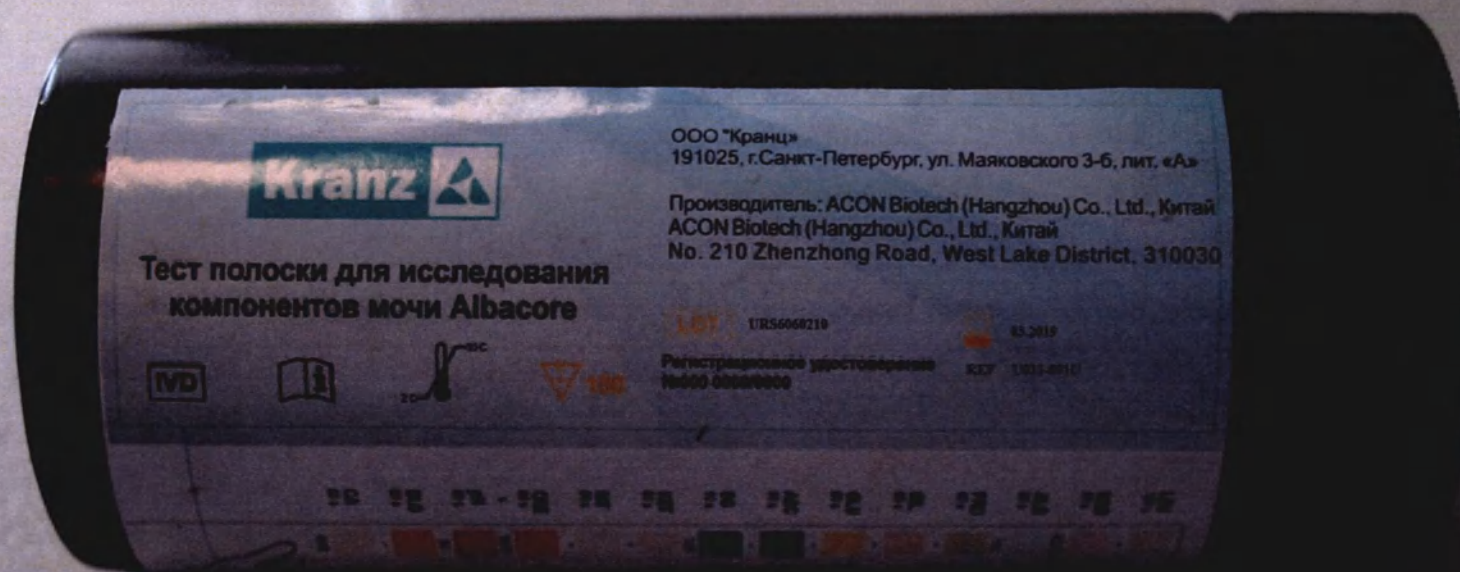


7. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albascore , 9 параметров (Глюкоза, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Удельный вес, Кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Лейкоциты) (GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, LEU)U031-092L



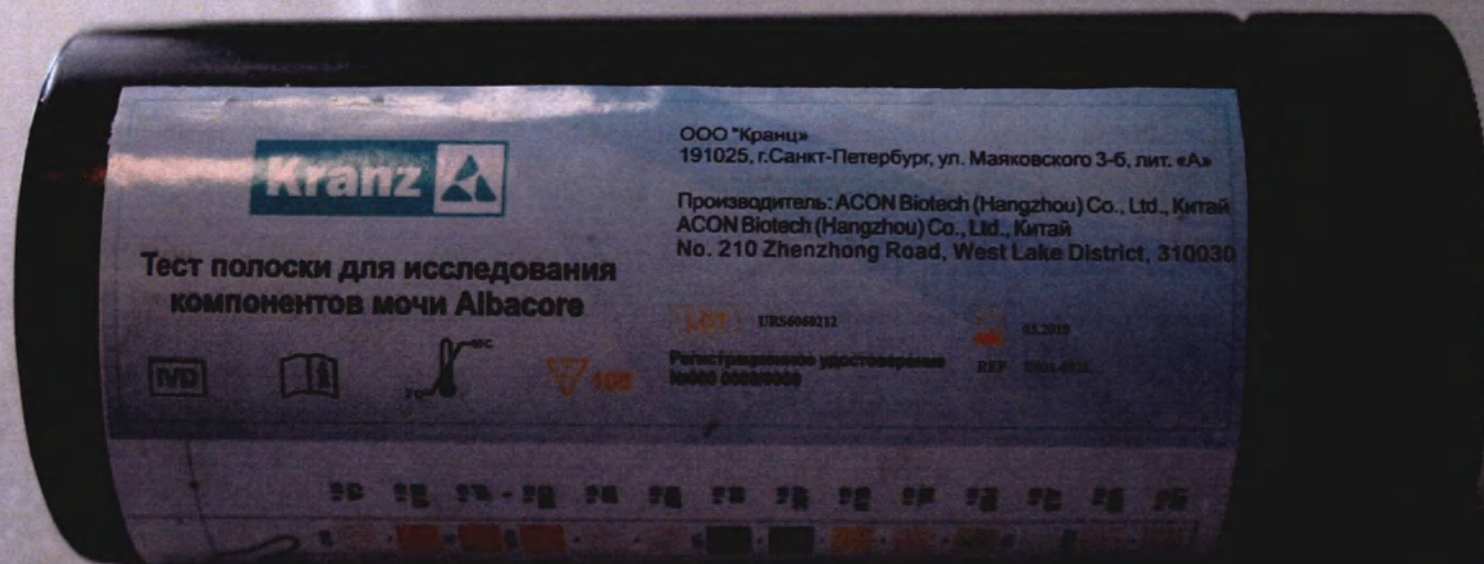

8. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albascore, 9 параметров (Аскорбиновая кислота, Глюкоза, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты) (ASC, GLU, BIL, KET, BLO, pH, PRO, URO, NIT) U031-092N



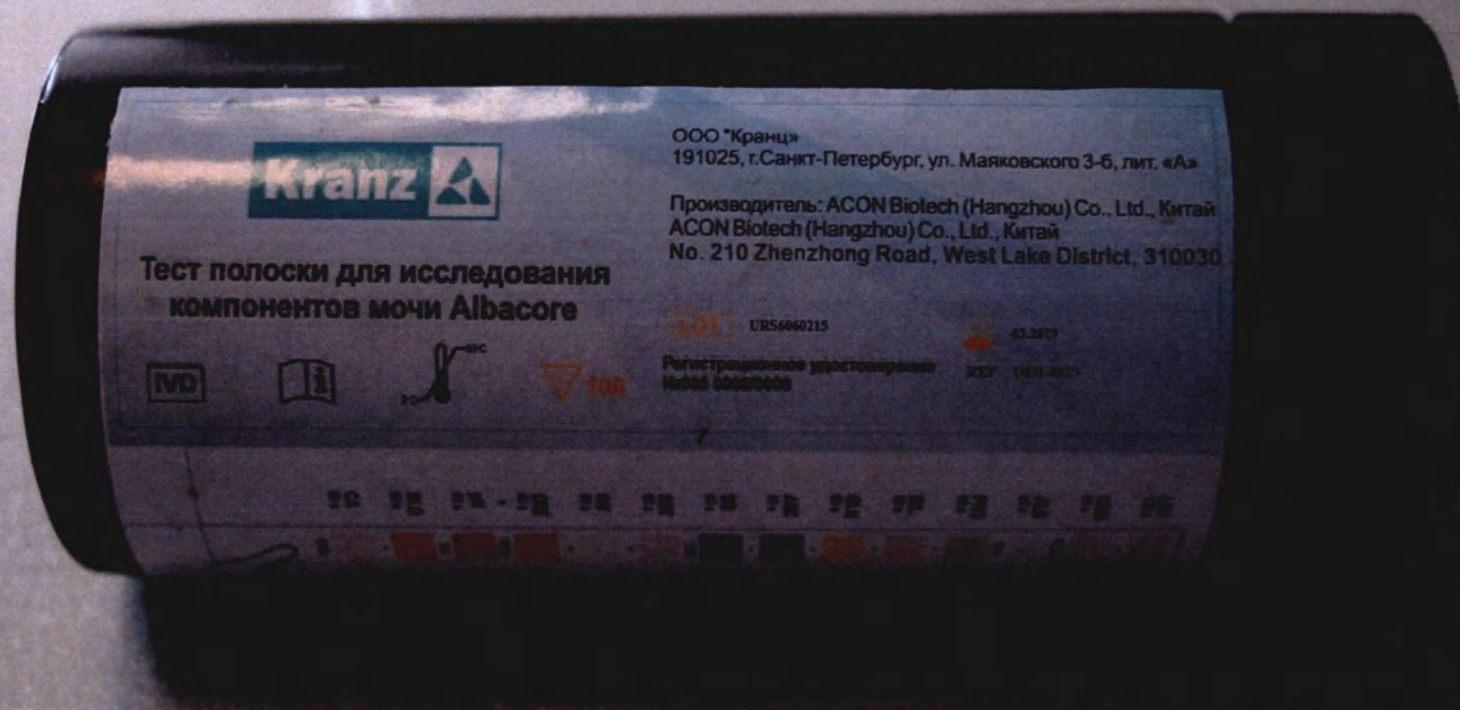


9. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore , 8 параметров (Глюкоза, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Удельный вес, Кровь, pH, Белок, Уробилиноген) (GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO) U031-080U





10. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albascore, 8 параметров (Глюкоза, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), рН, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты) (GLU, BIL, KET, pH, PRO, URO, NIT, LEU) U031-081U




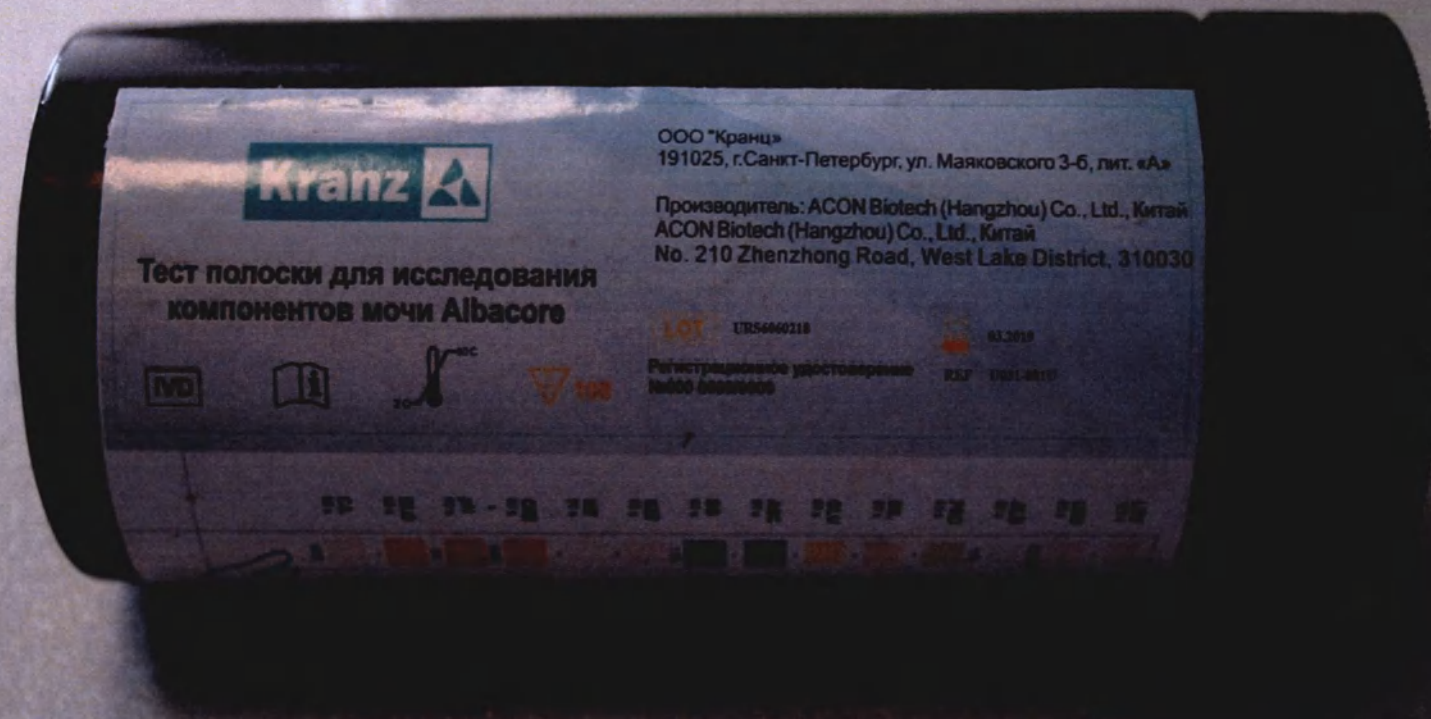


11. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albasoge , 8 параметров (Глюкоза, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты) (GLU, BIL, KET, BLO, pH, PRO, URO, NIT) U031-081N




дата

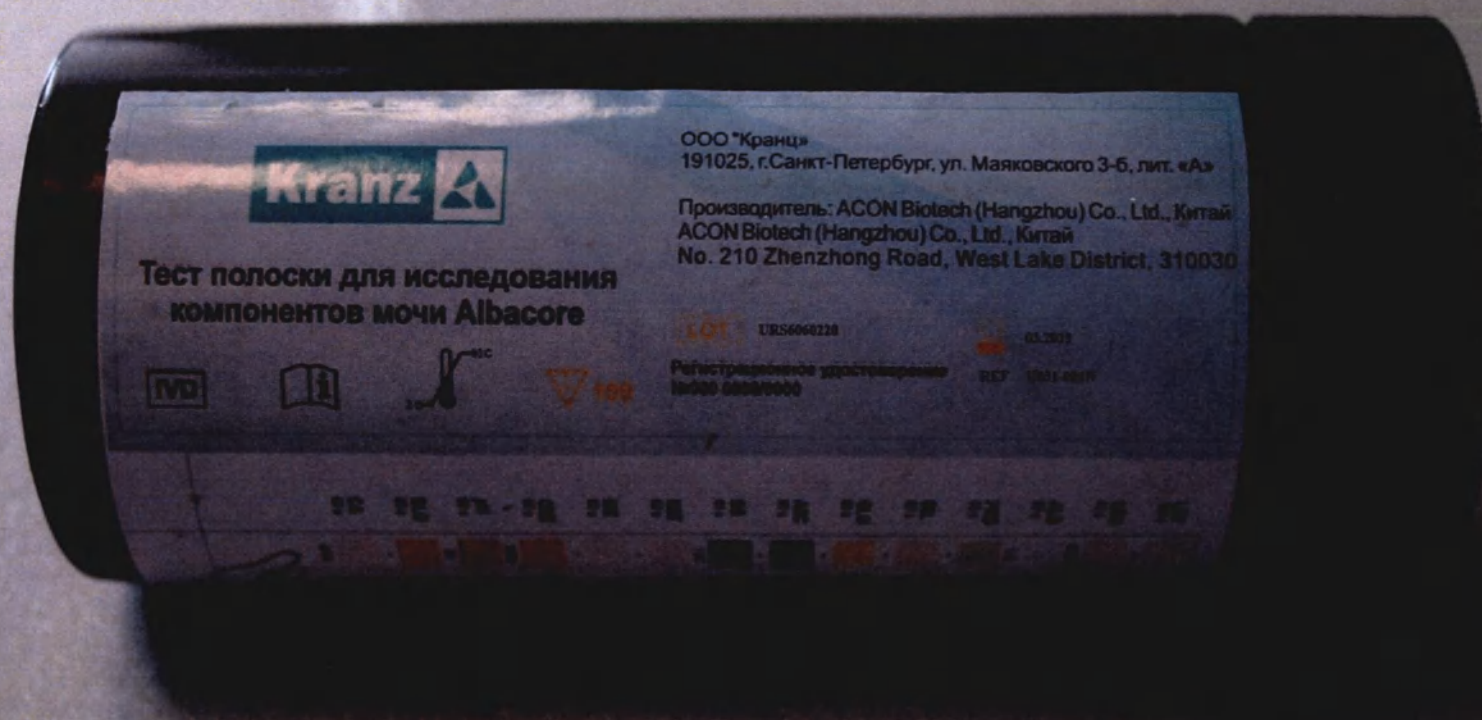


12. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albascore , 8 параметров (Глюкоза, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Удельный вес, Кровь, pH, Белок, Нитриты, Лейкоциты) (GLU, KET, SG, BLO, pH, PRO, NIT, LEU) U031-081K

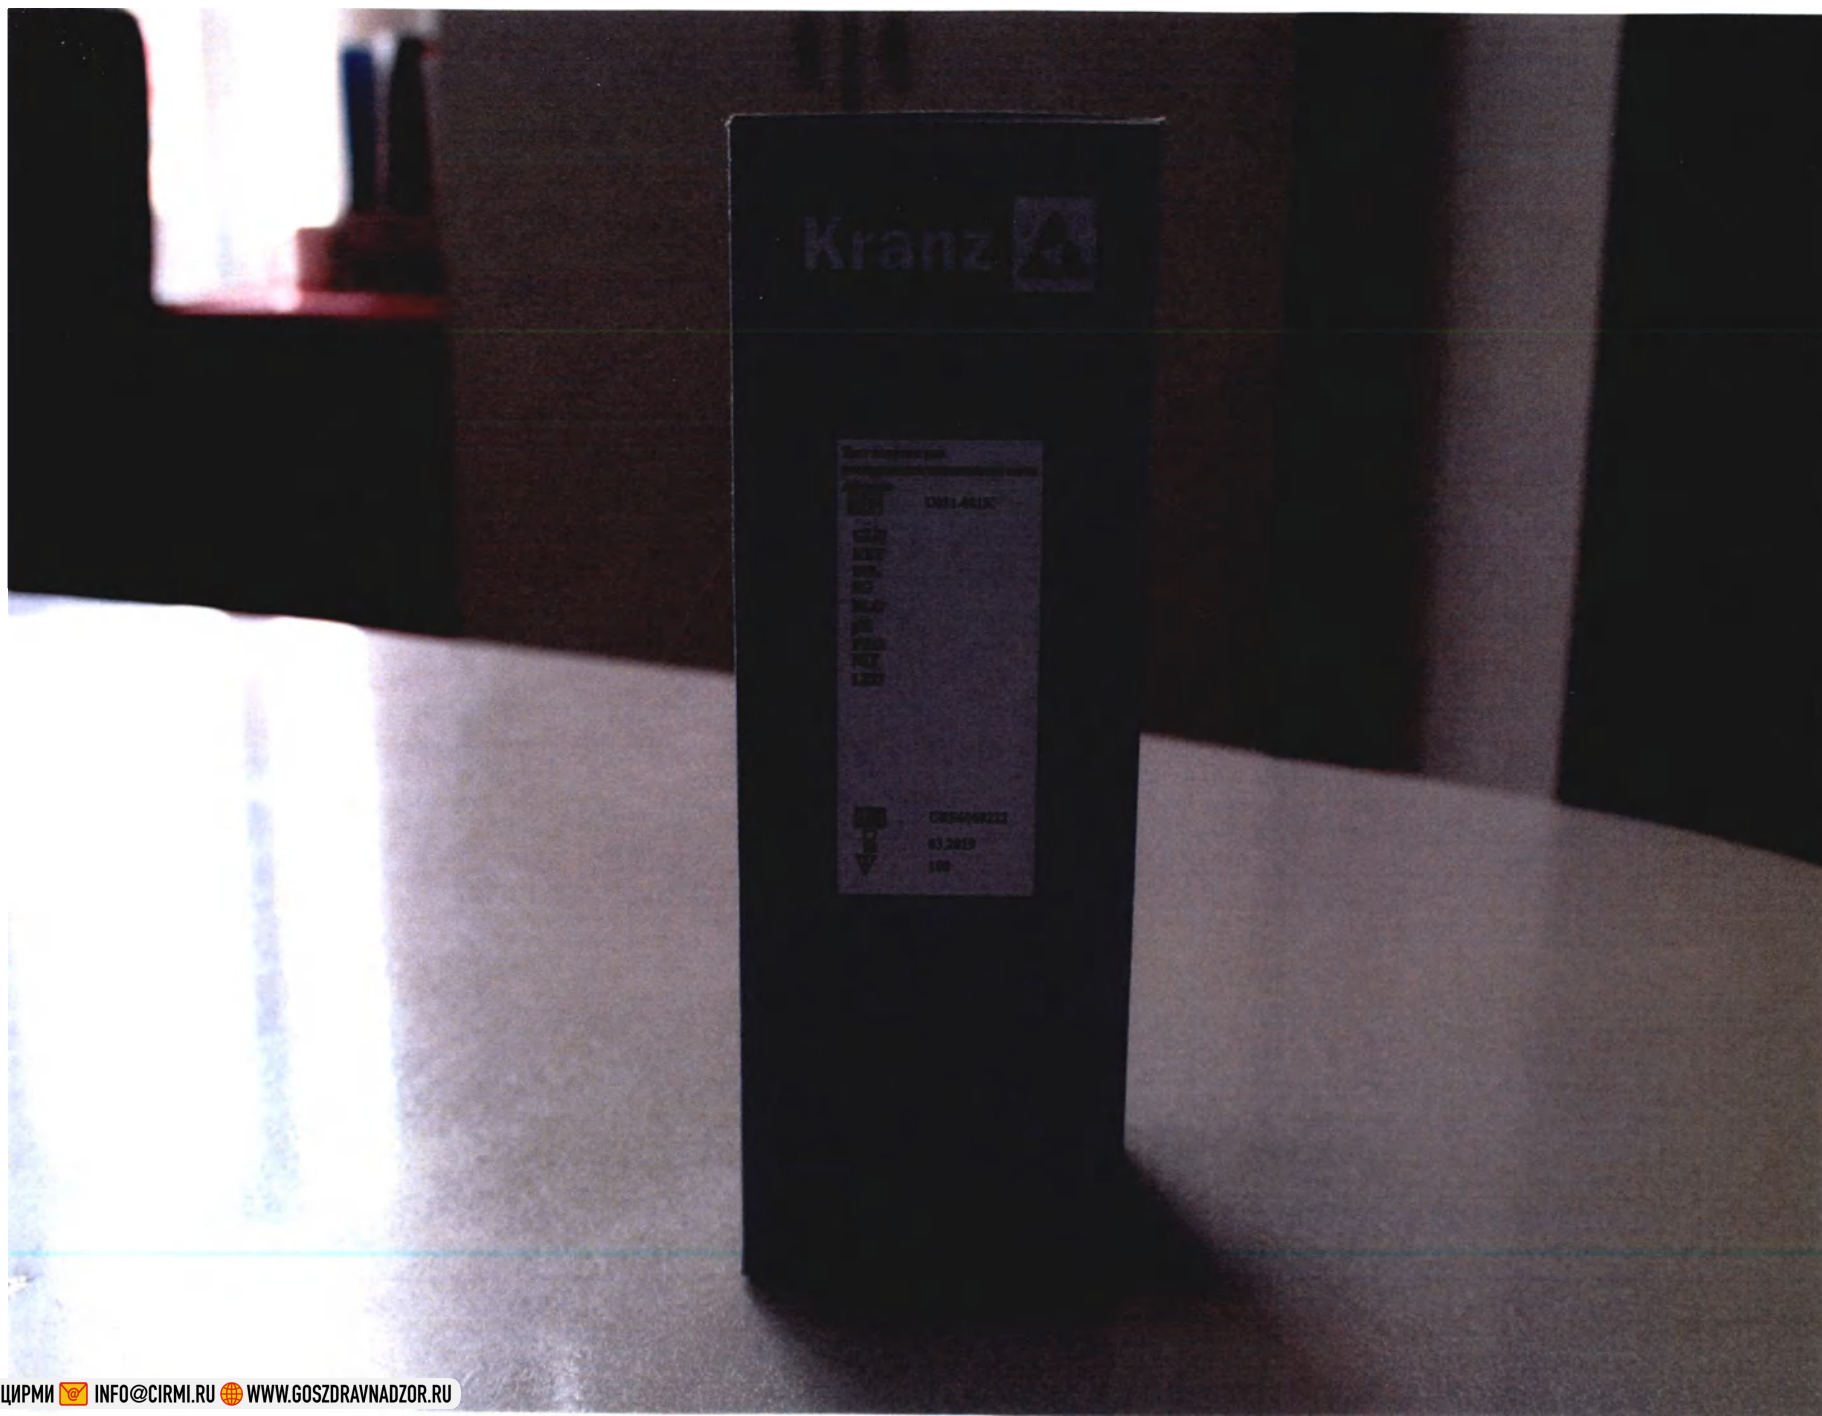

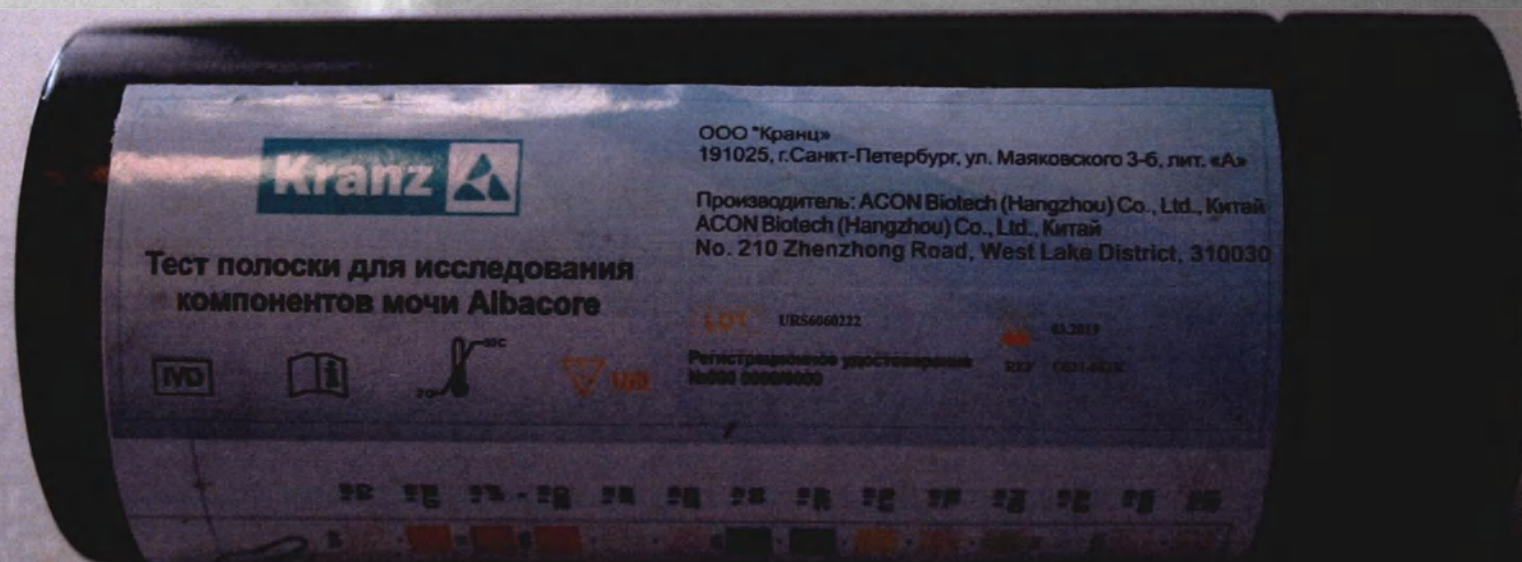


13. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore , 8 параметров (Глюкоза, Удельный вес, Кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты) (GLU, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU) U031-081S



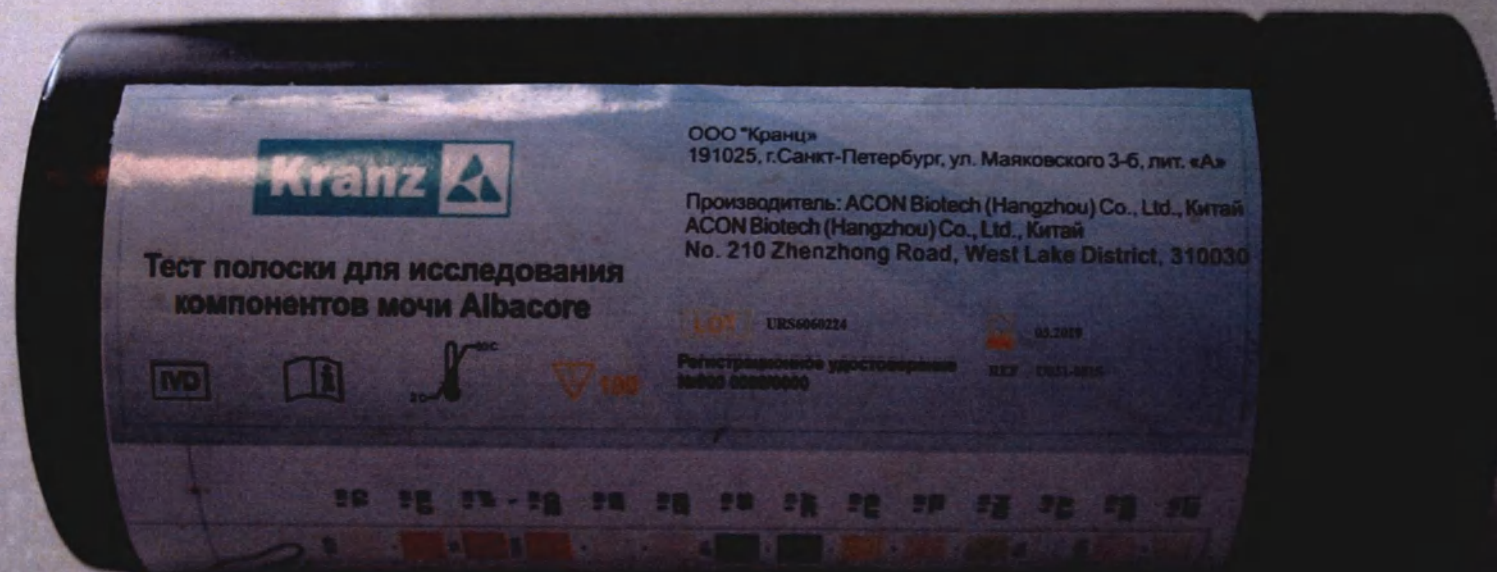


14. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore , 7 параметров (Глюкоза, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Кровь, pH, Белок, Альбумин, Креатинин) (GLU, KET, BLO, pH, PRO, ALB, CRE) U031-072A



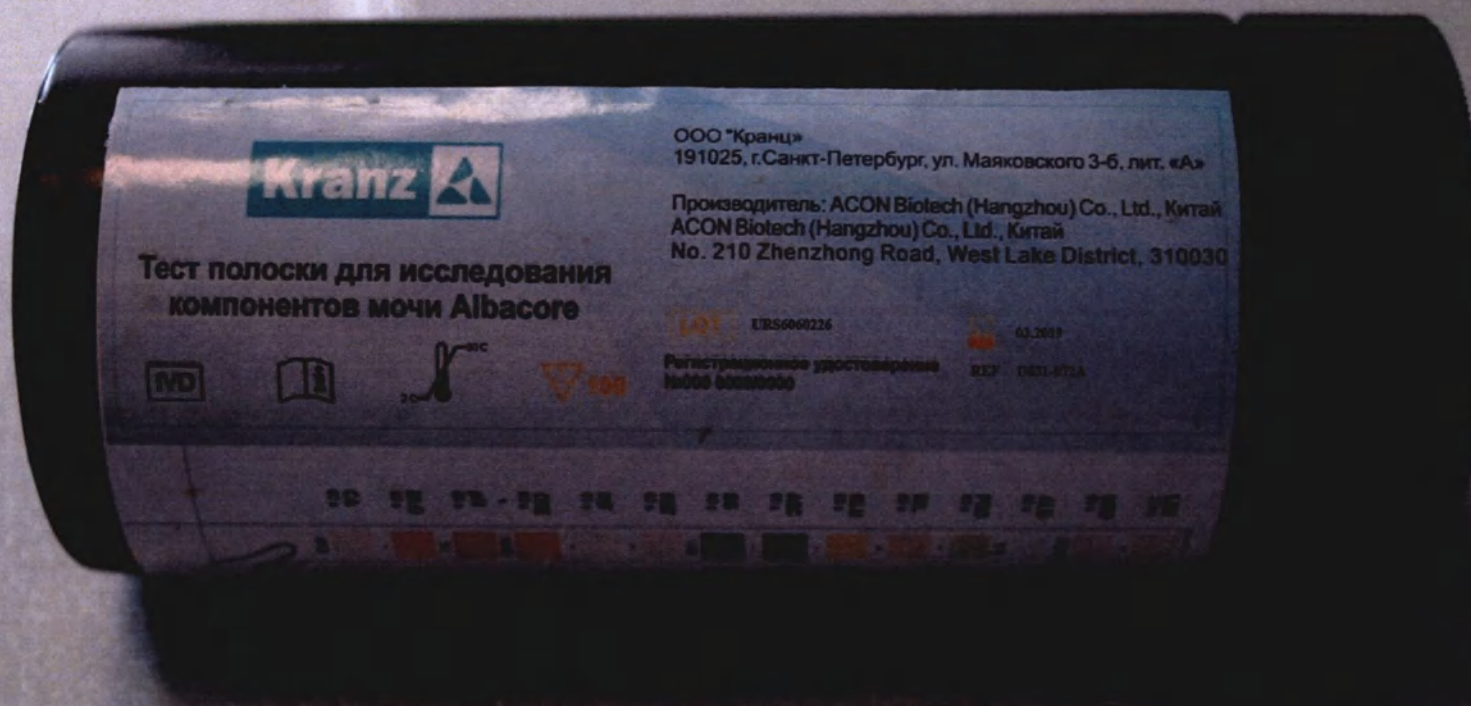


15. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore , 7 параметров (Глюкоза, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Кровь, pH, Белок, Уробилиноген) (GLU, BIL, KET, BLO, pH, PRO, URO) U031-072U



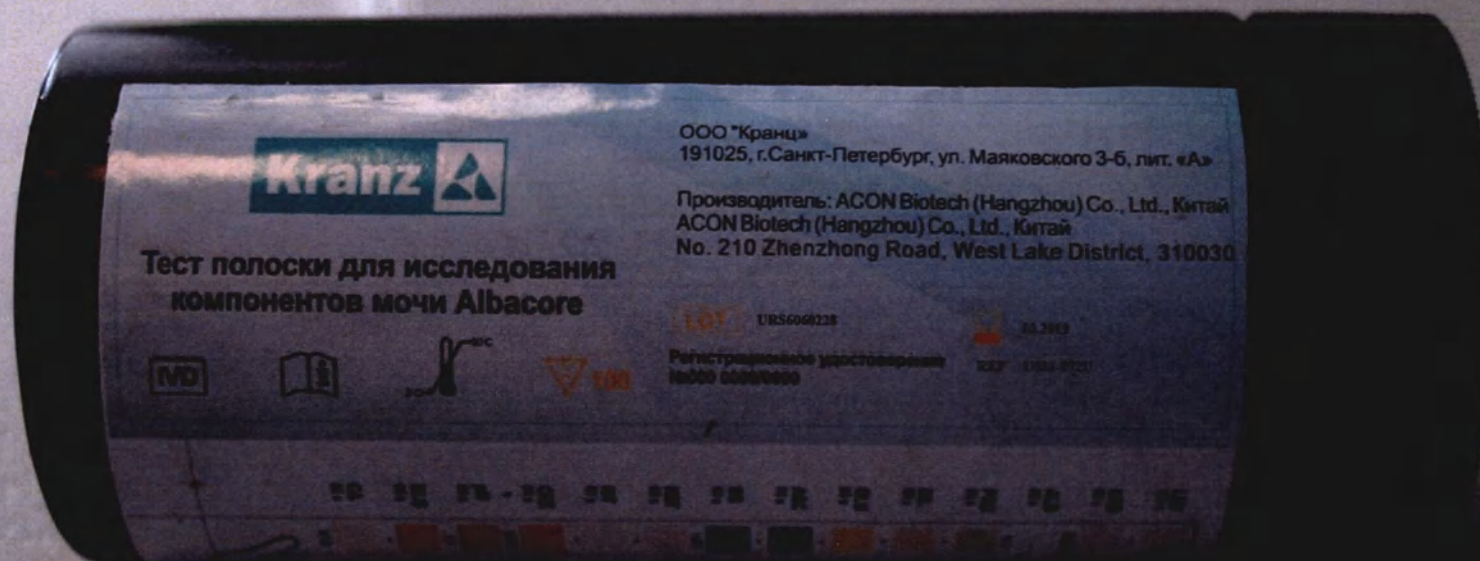


16. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albascore, 7 параметров (Глюкоза, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Кровь, pH, Белок, Нитриты, Лейкоциты) (GLU, KET, BLO, pH, PRO, NIT, LEU) U031-071N



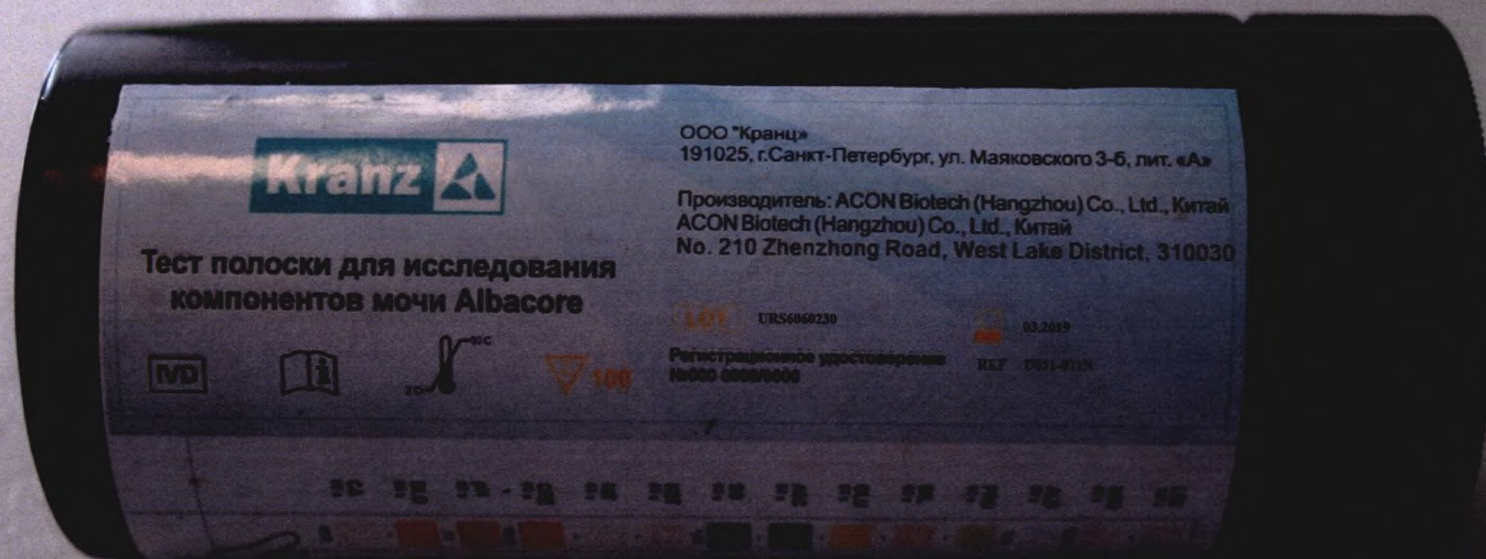



17. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore , 6 параметров (Глюкоза, Кровь, pH, Белок, Нитриты, Лейкоциты) (GLU, BLO, pH, PRO, NIT, LEU) U031-061N



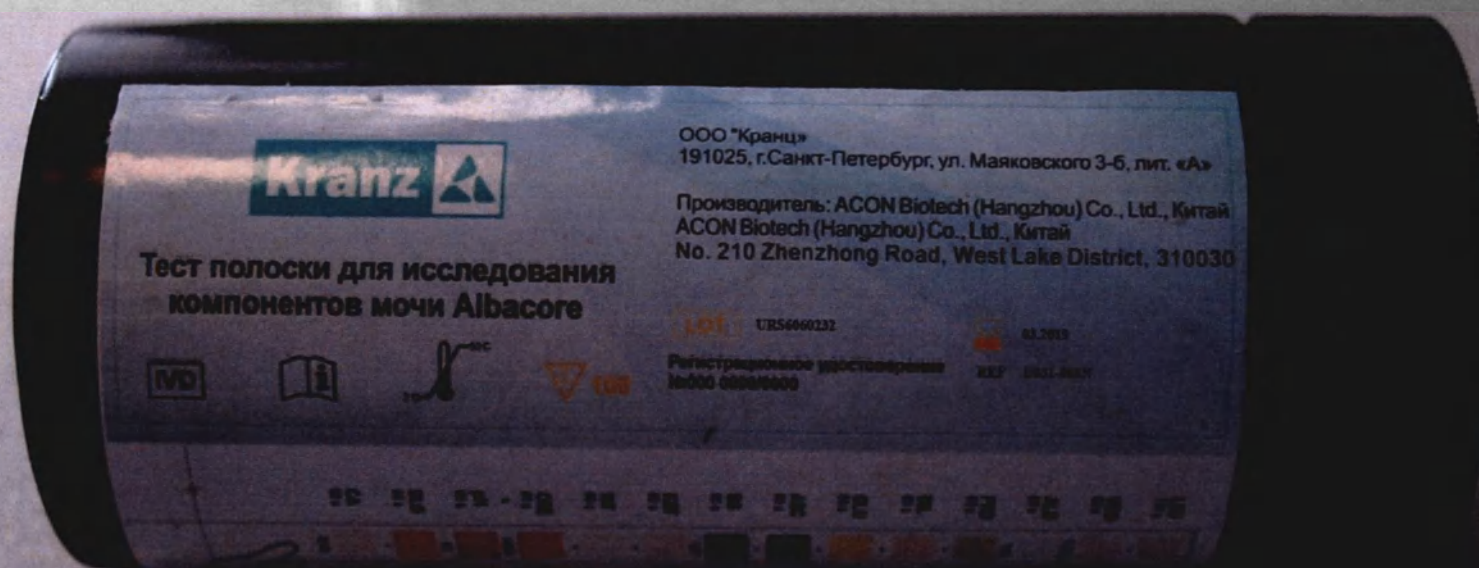


18. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore , 6 параметров (Глюкоза, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Кровь, pH, Белок, Уробилиноген) (GLU, KET, BLO, pH, PRO, URO) U031-062R

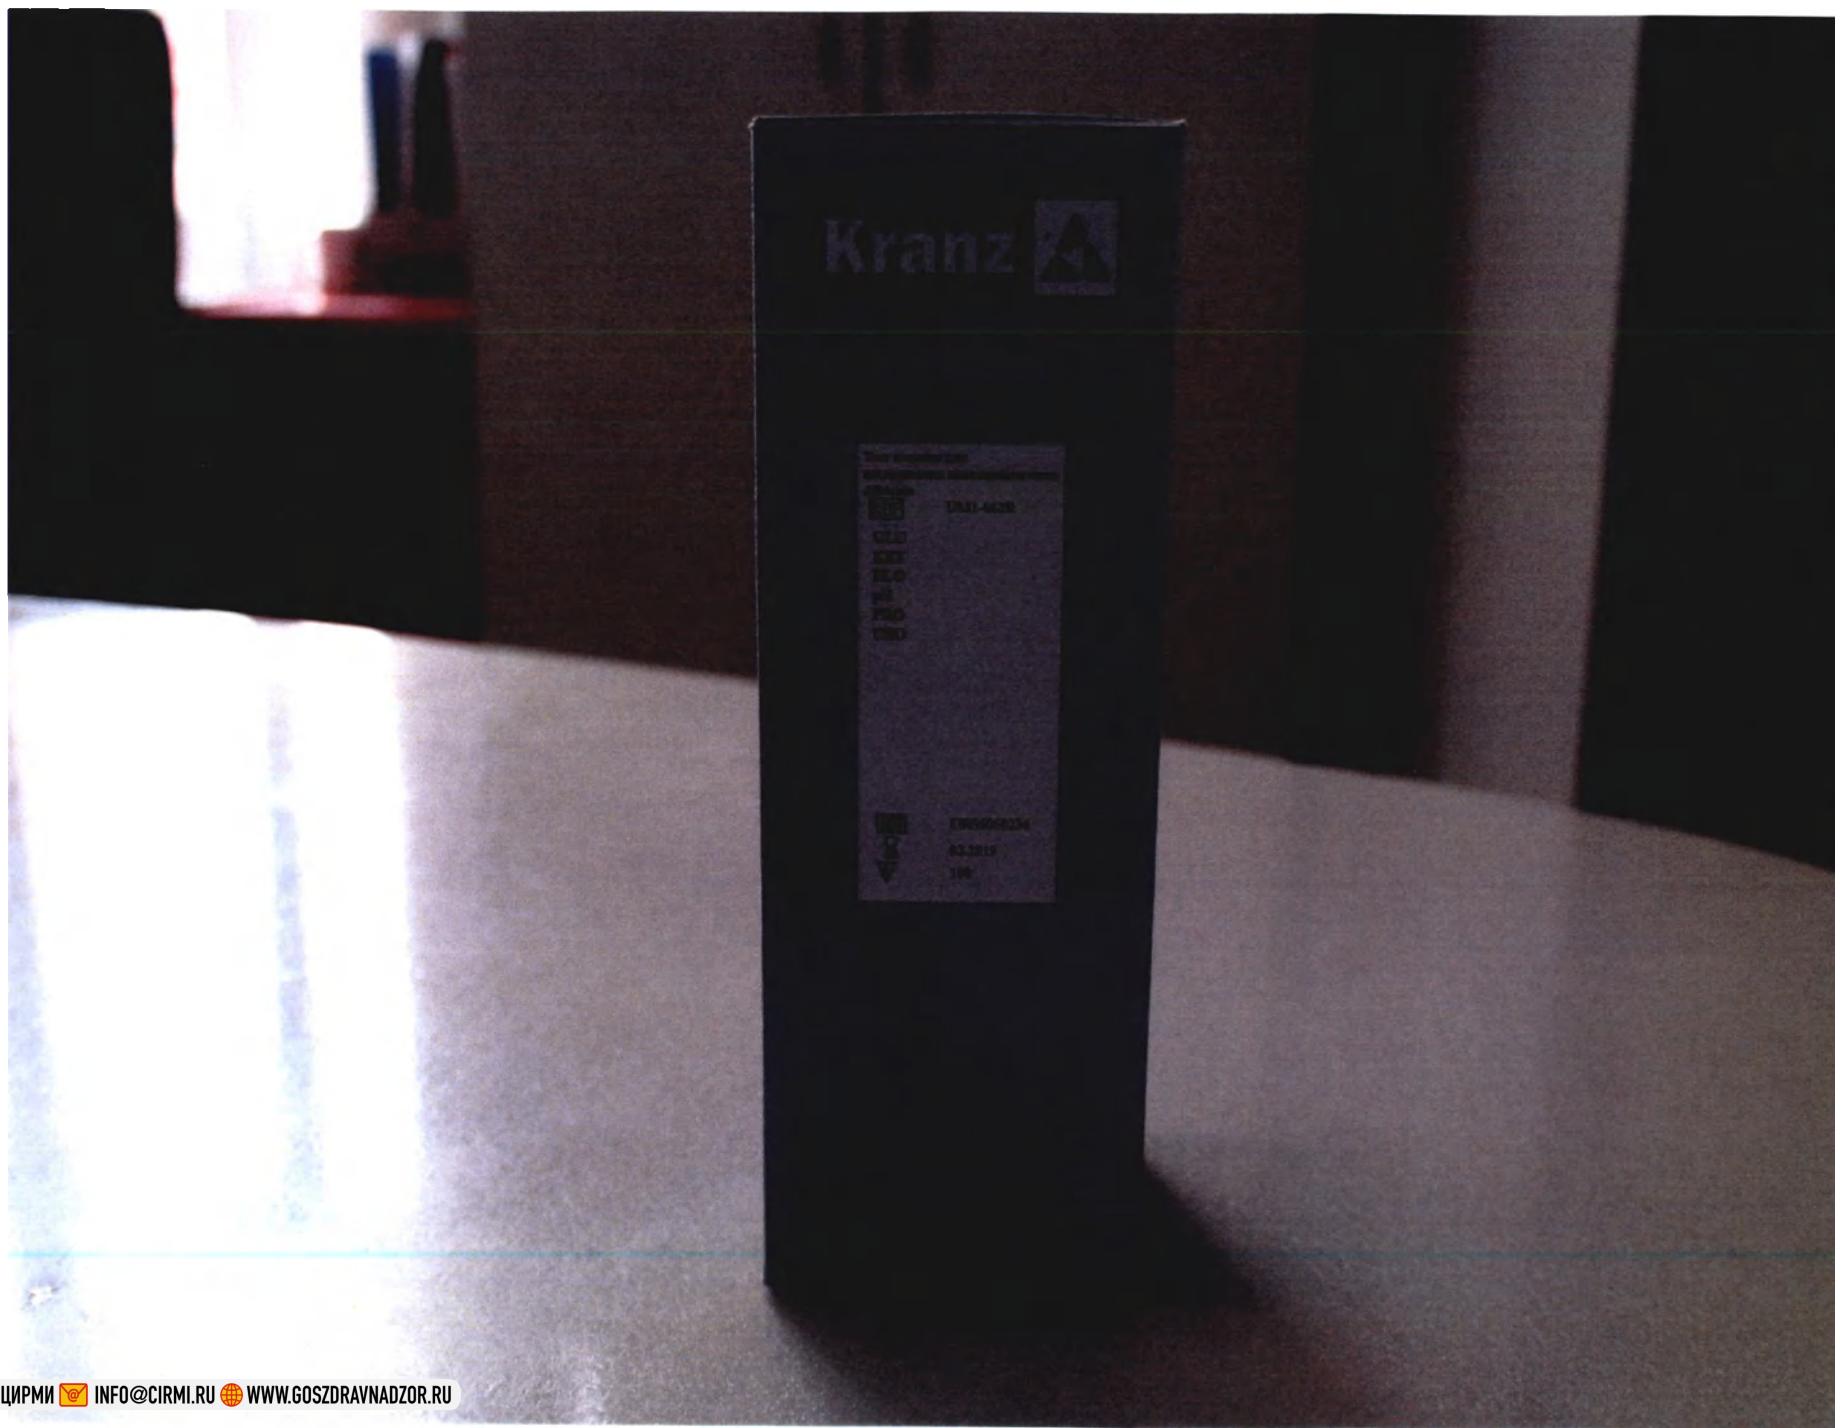

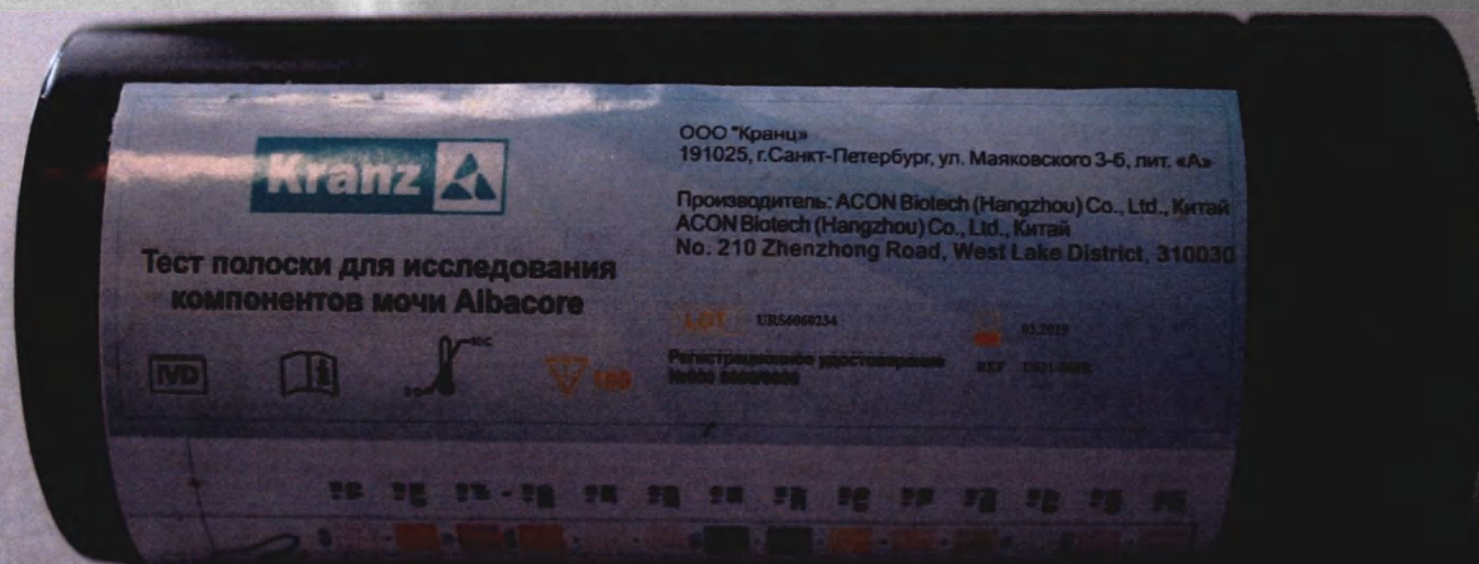


19. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore , 6 параметров (Билирубин, Удельный вес, Кровь, Белок, Уробилиноген, Нитриты) (BIL, SG, BLO, PRO, URO, NIT) U031-061U



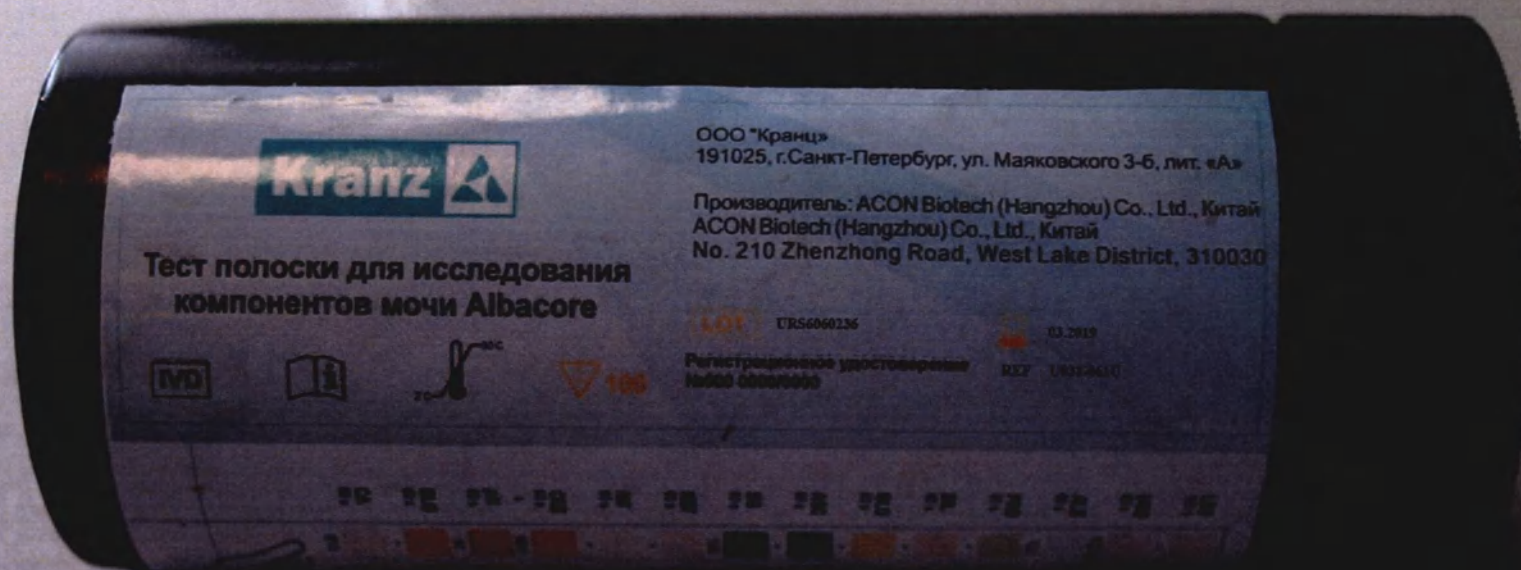



20. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore , 5 параметров (Глюкоза, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Кровь, pH, Белок) (GLU, KET, BLO, pH, PRO) U031-051B



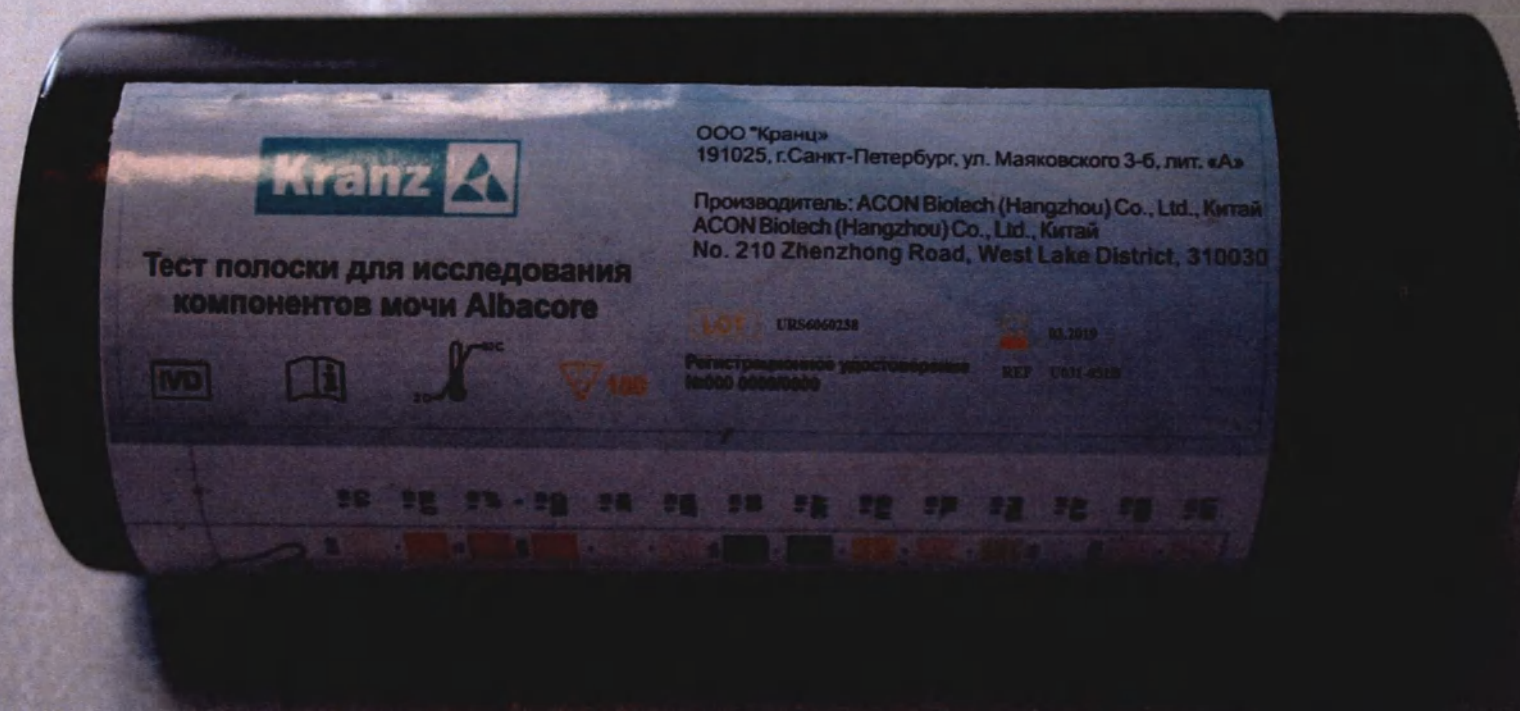



21. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore , 5 параметров (Глюкоза, рН, Белок, Альбумин, Креатинин) (GLU, pH, PRO, ALB, CRE) U031-052C

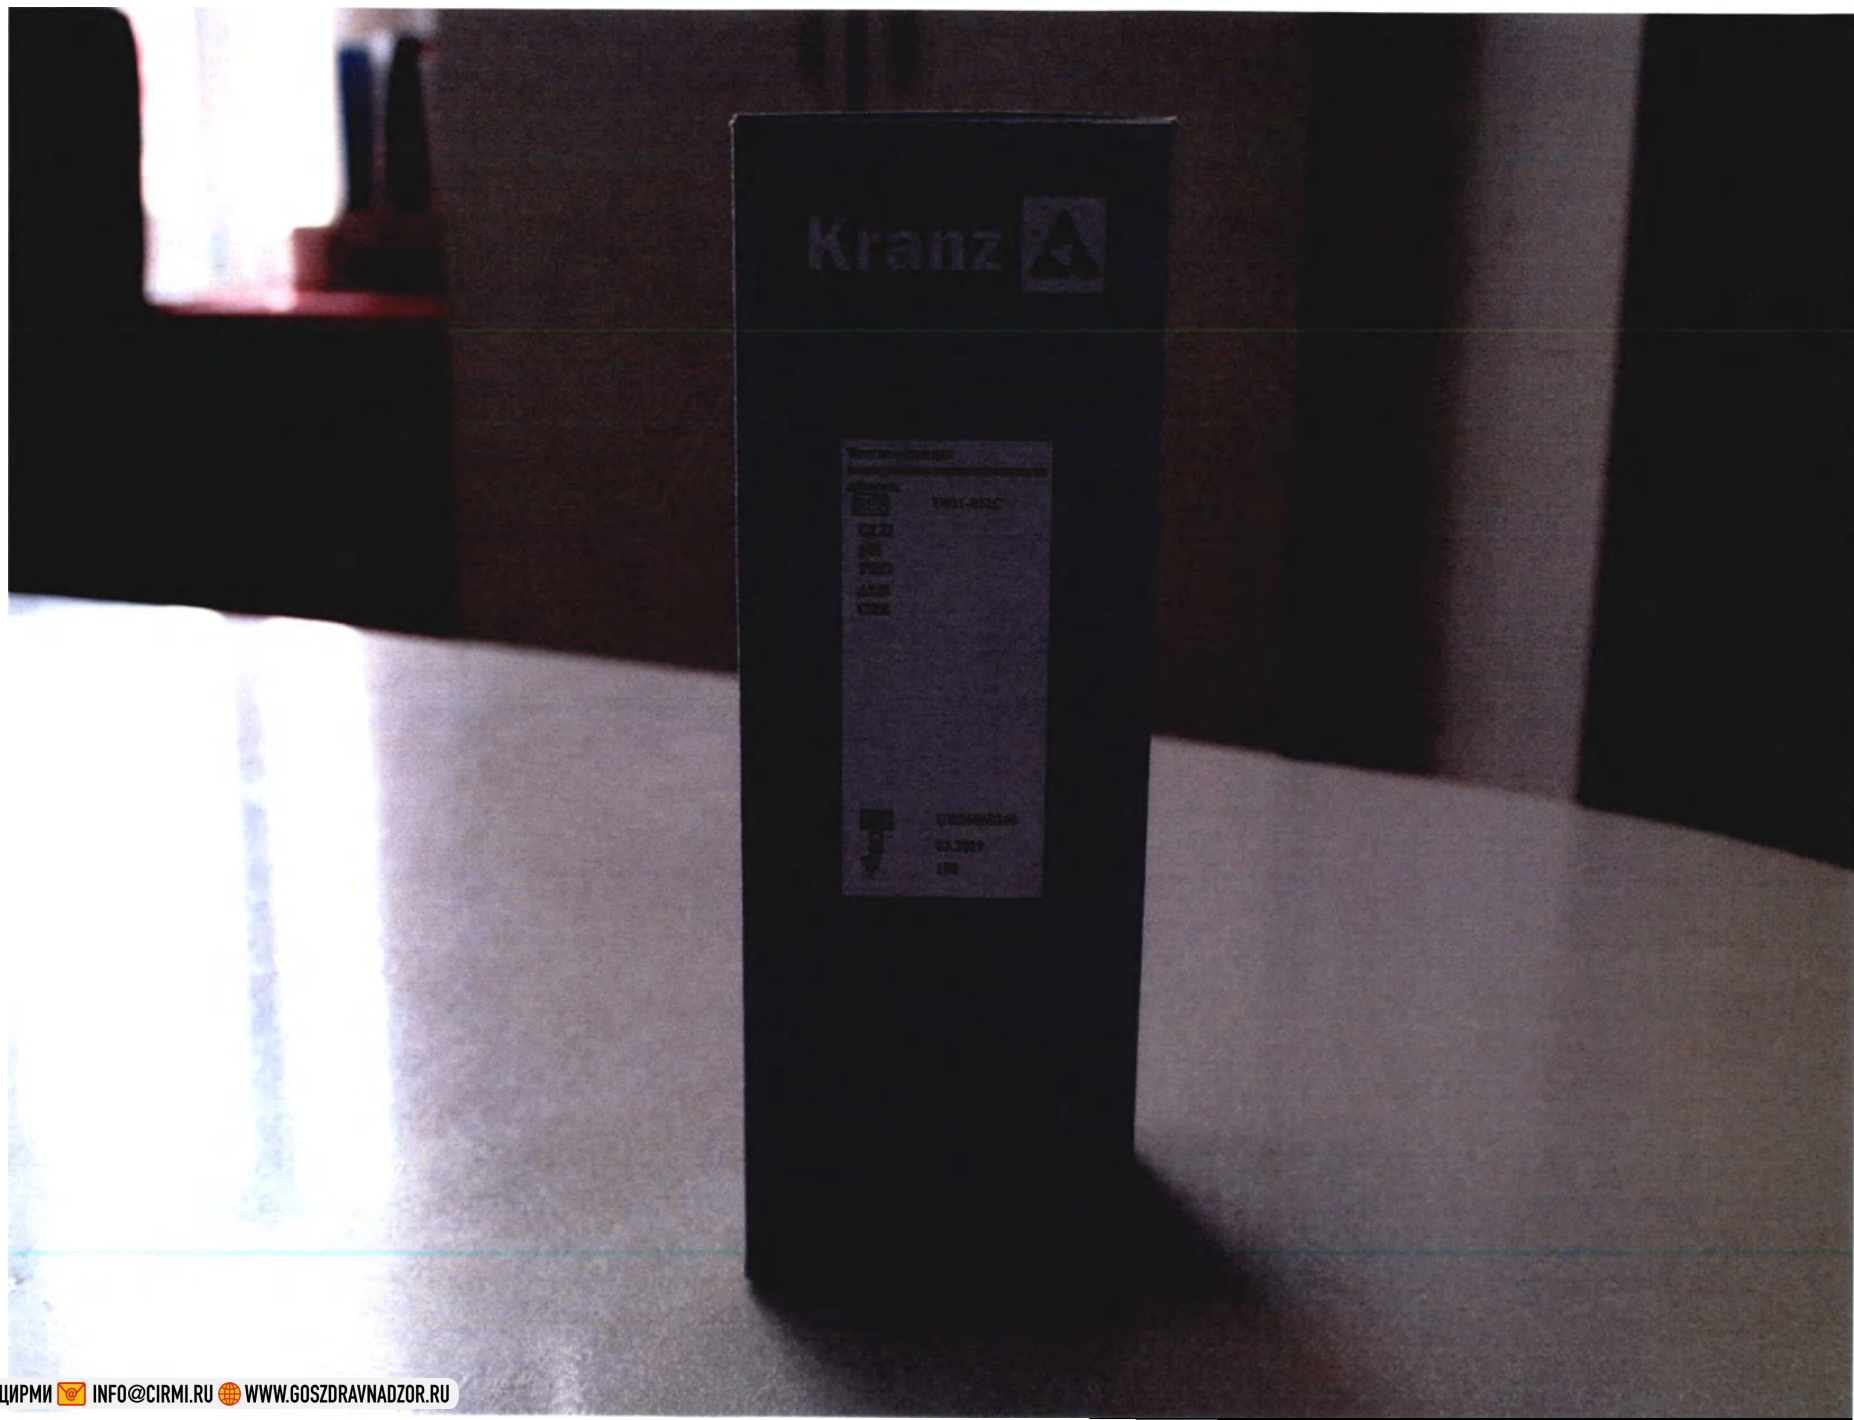

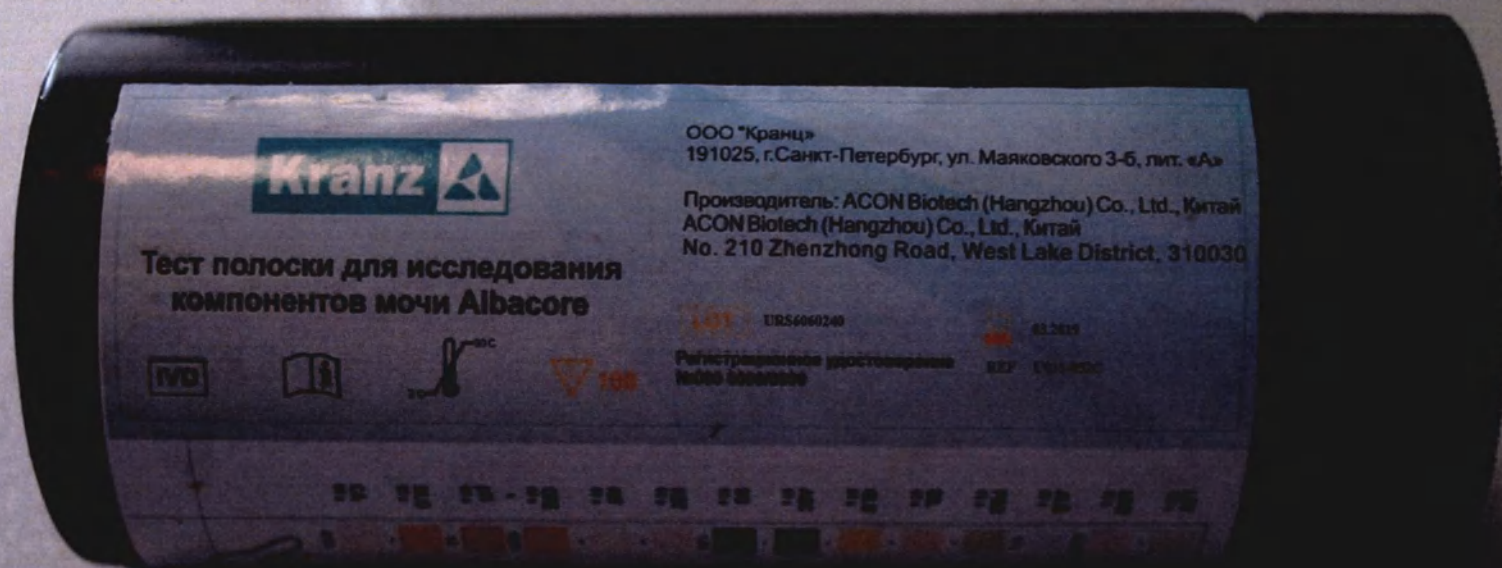


22. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore , 5 параметров (Глюкоза, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Белок, Альбумин, Креатинин) (GLU, KET, PRO, ALB, CRE) U031-053R

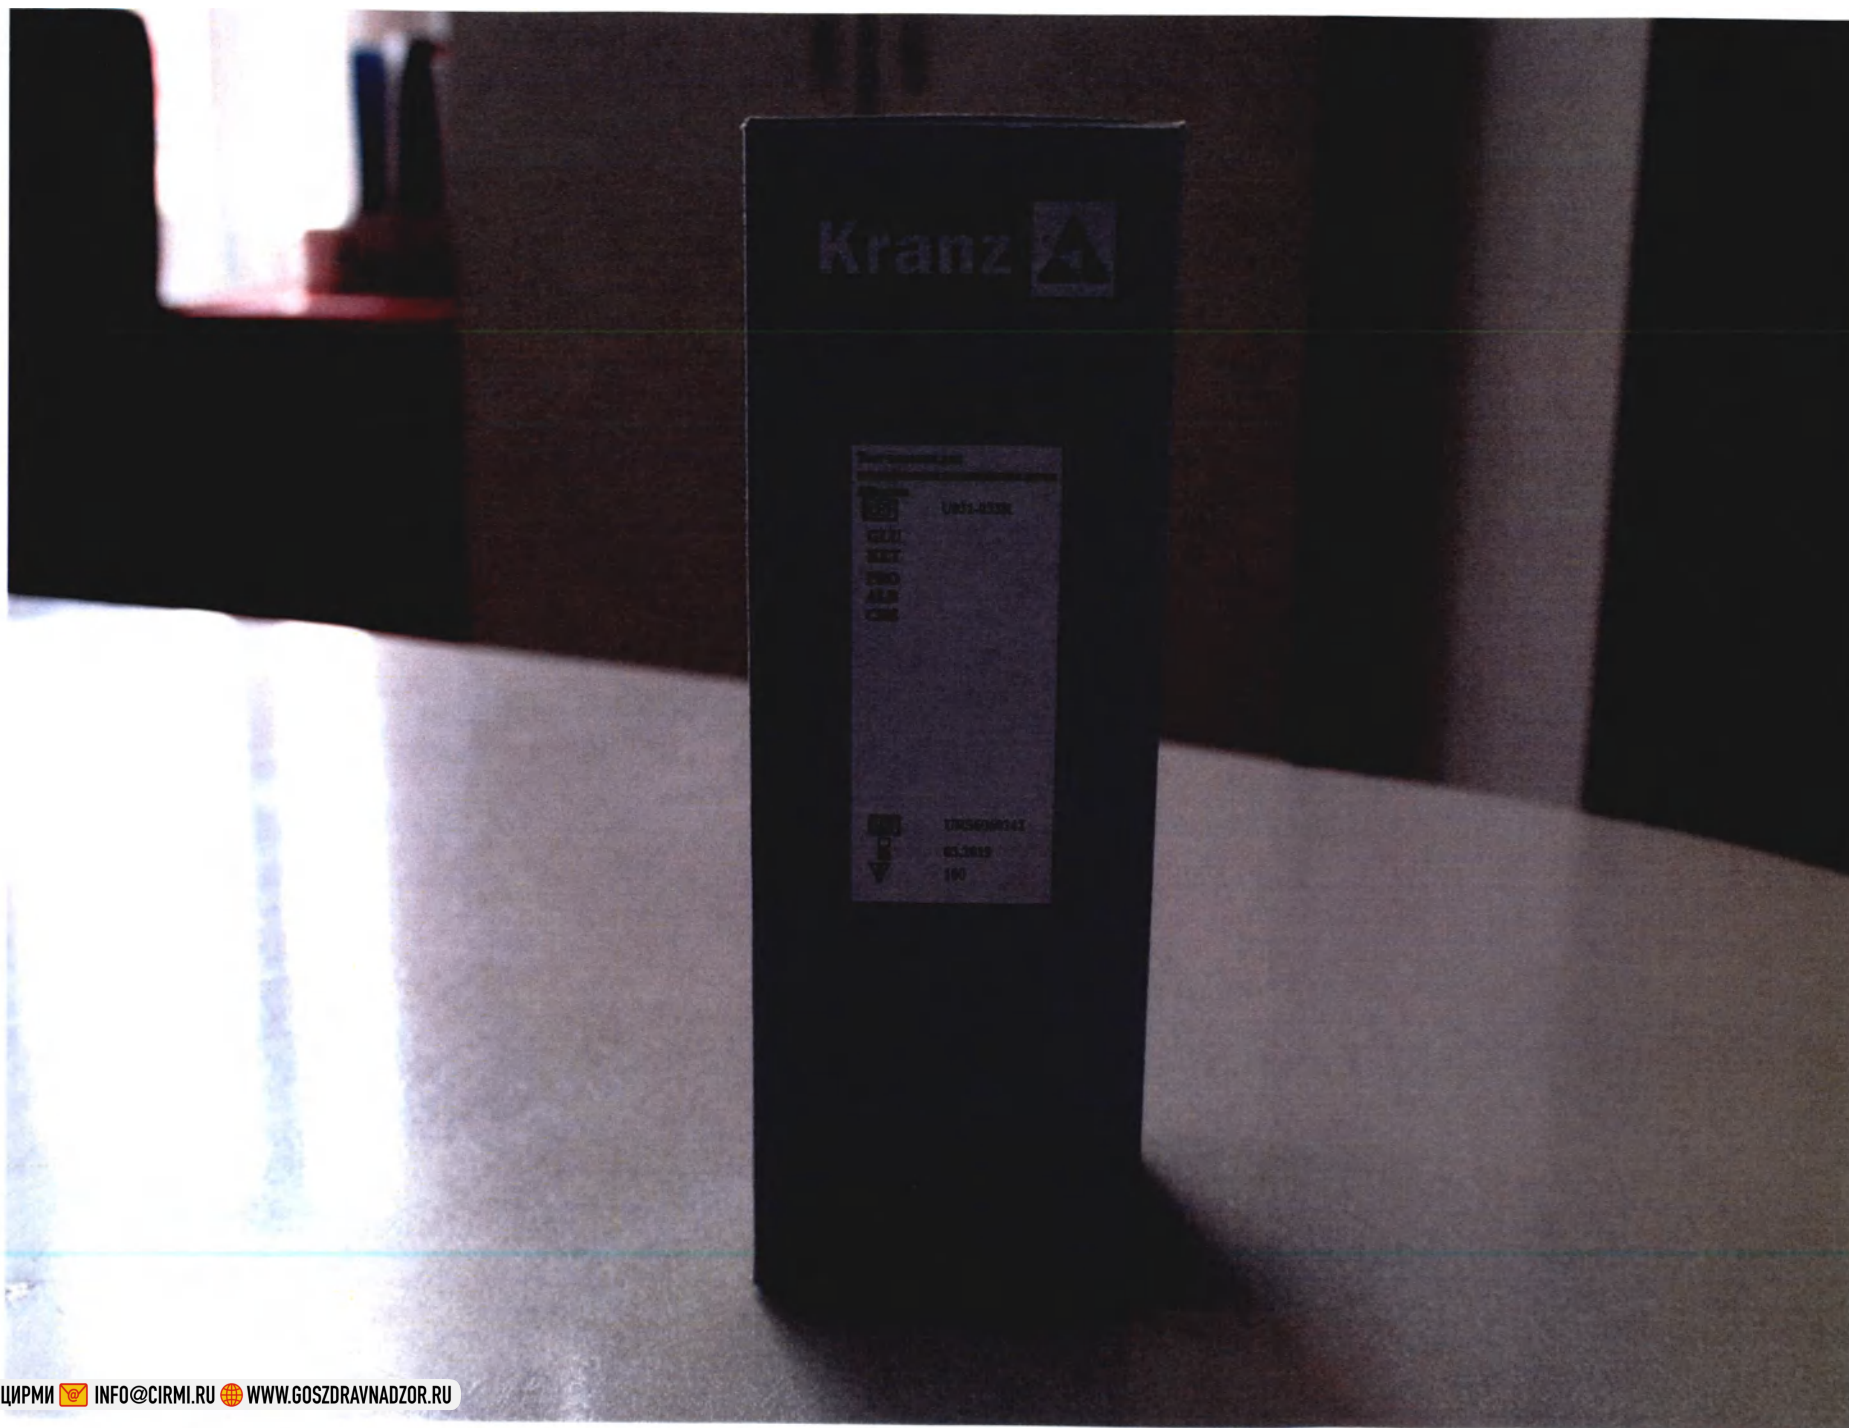

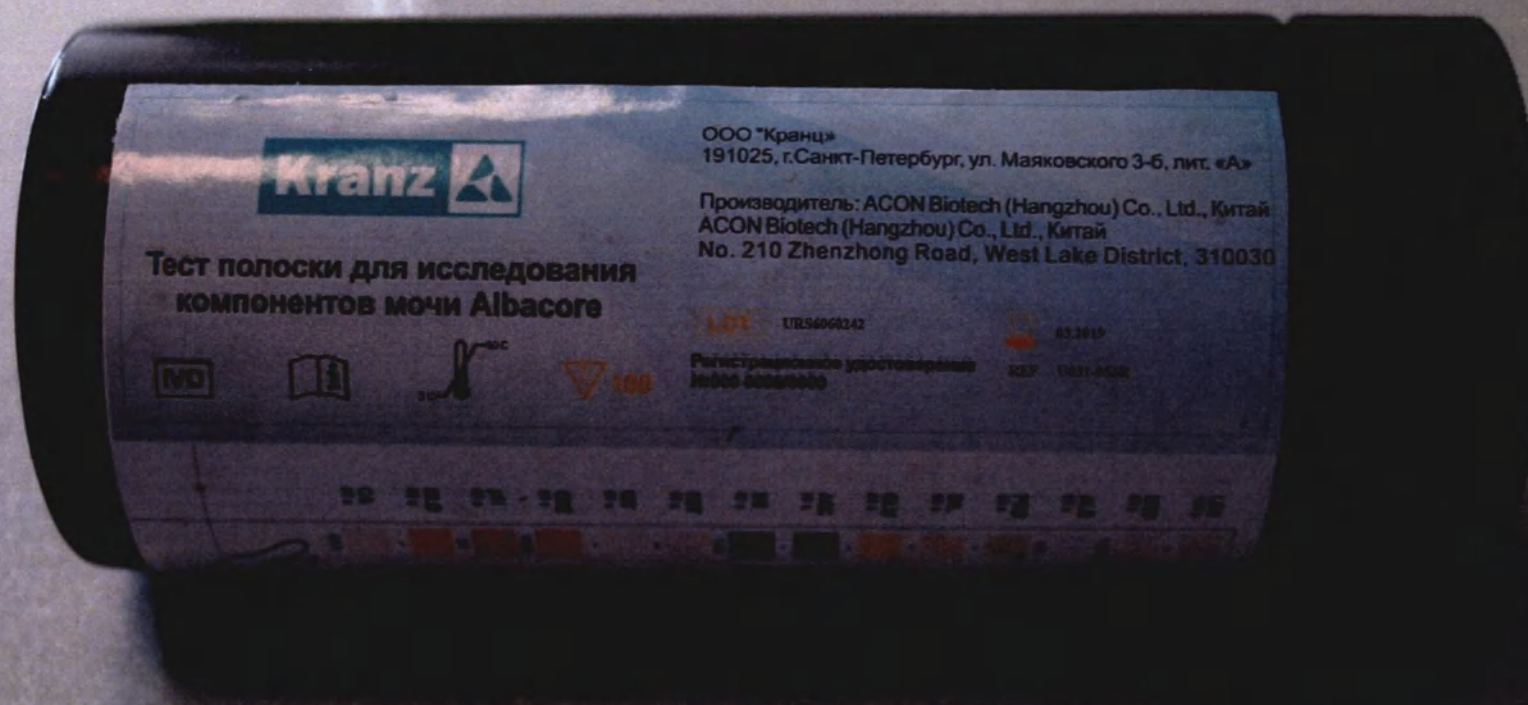


23. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore , 5 параметров (Глюкоза, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Кровь, pH, Белок) (GLU, KET, BLO, pH, PRO) U031-054P



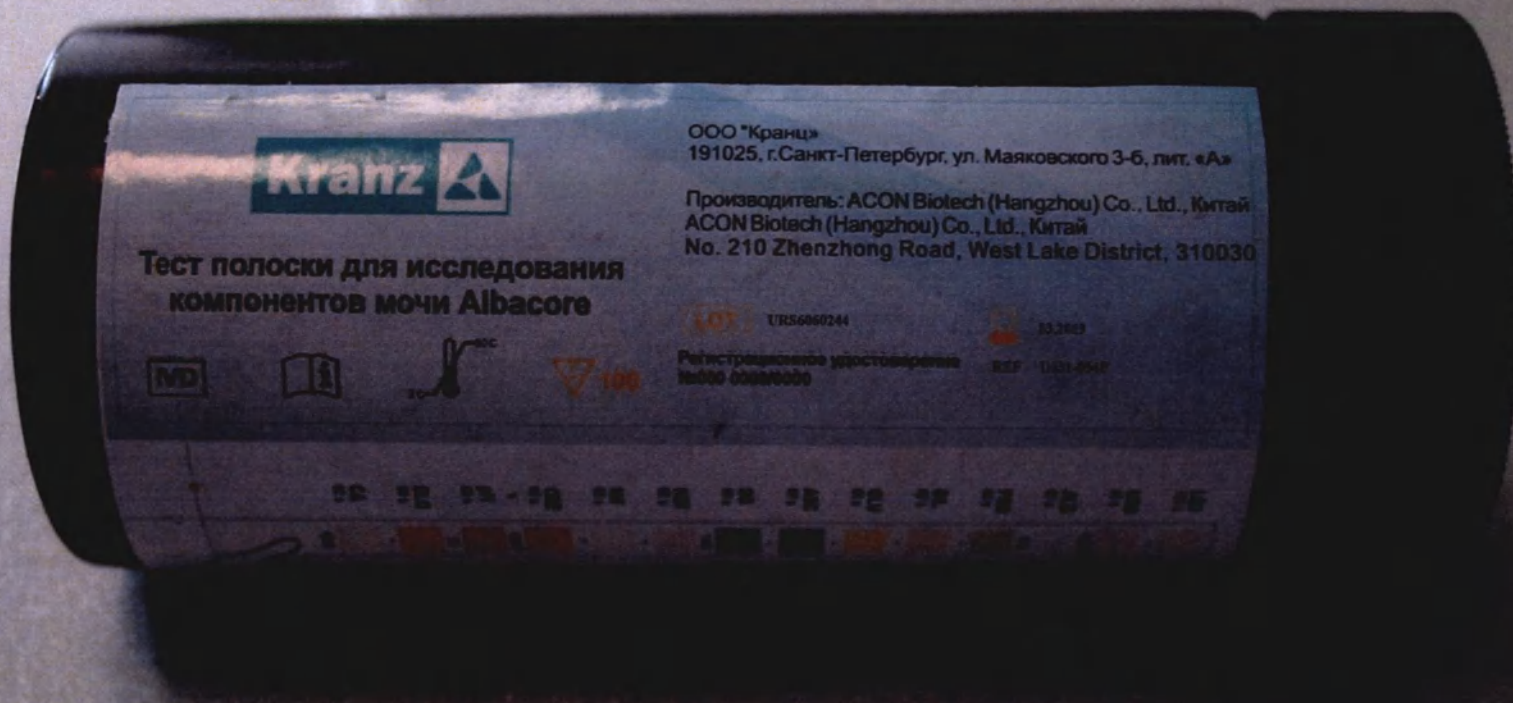


24. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore , 5 параметров (Кровь, pH, Белок, Нитриты, Лейкоциты) (BLO, pH, PRO, NIT, LEU) U031-055L



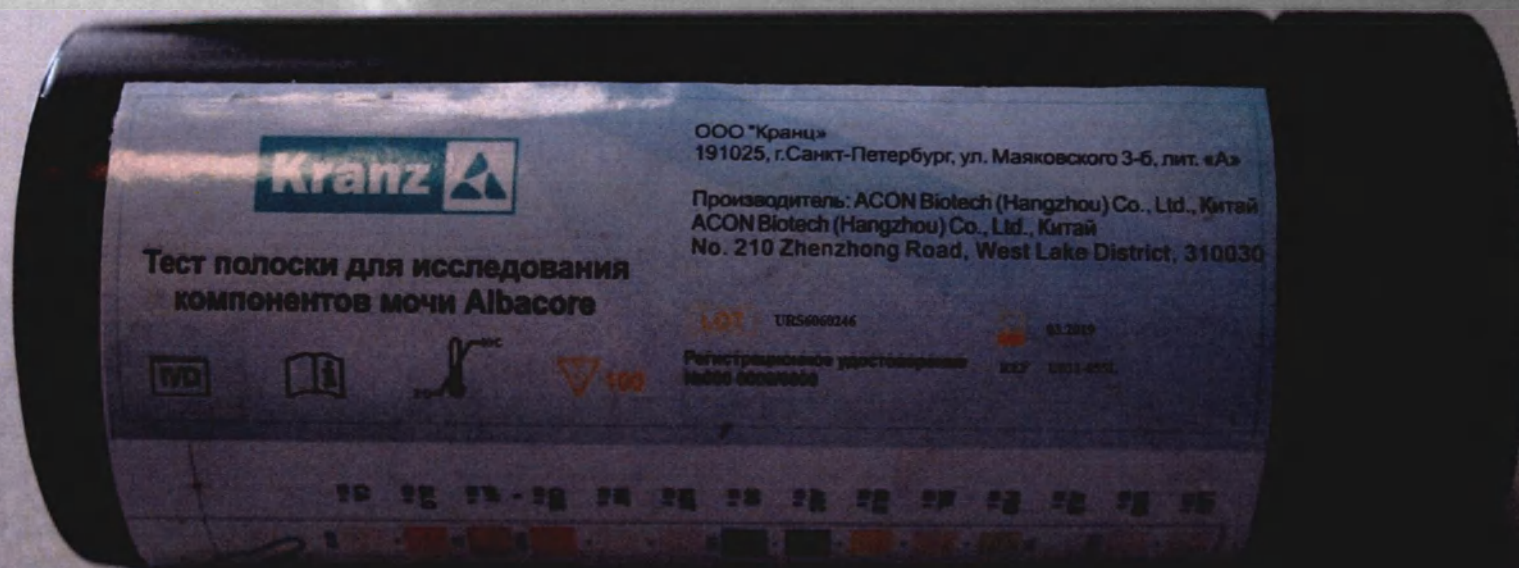



25. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore , 5 параметров (Билирубин, Кровь, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты)
 (BIL, BLO, URO, NIT, LEU) U031-051U



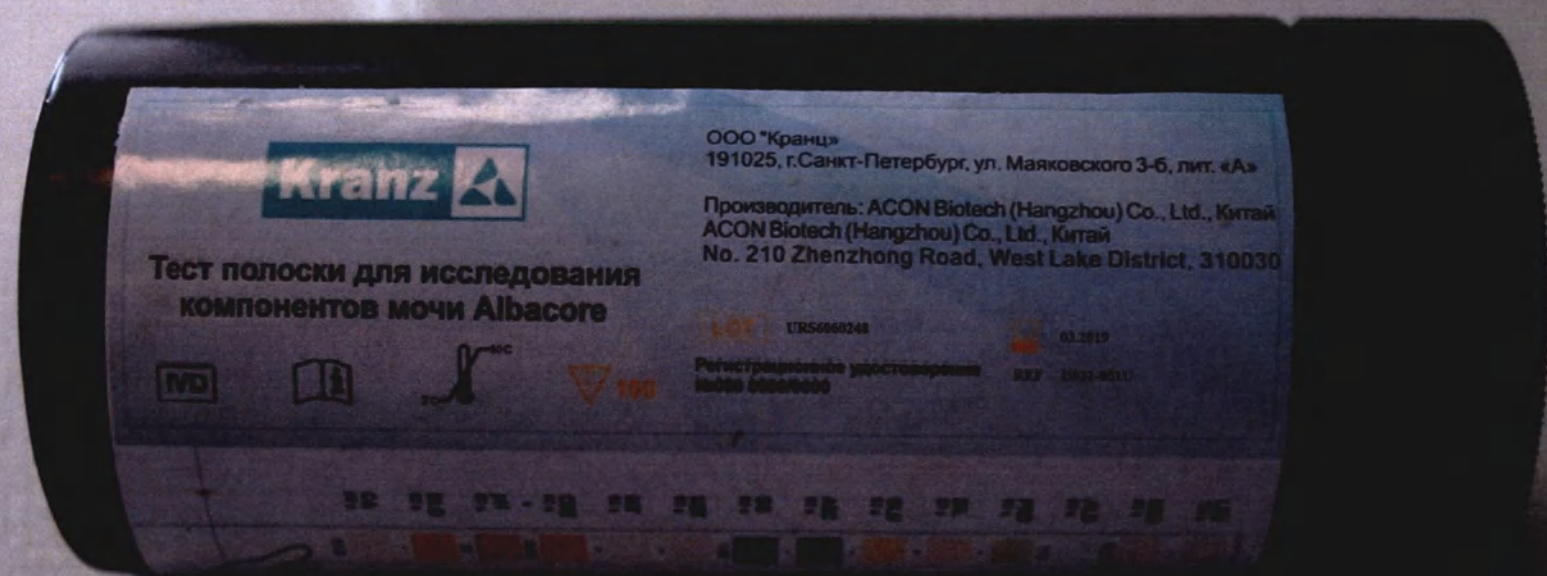



26. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, 5 параметров (Глюкоза, Удельный вес, Кровь, pH, Белок) (GLU, SG, BLO, pH, PRO) U031-051S

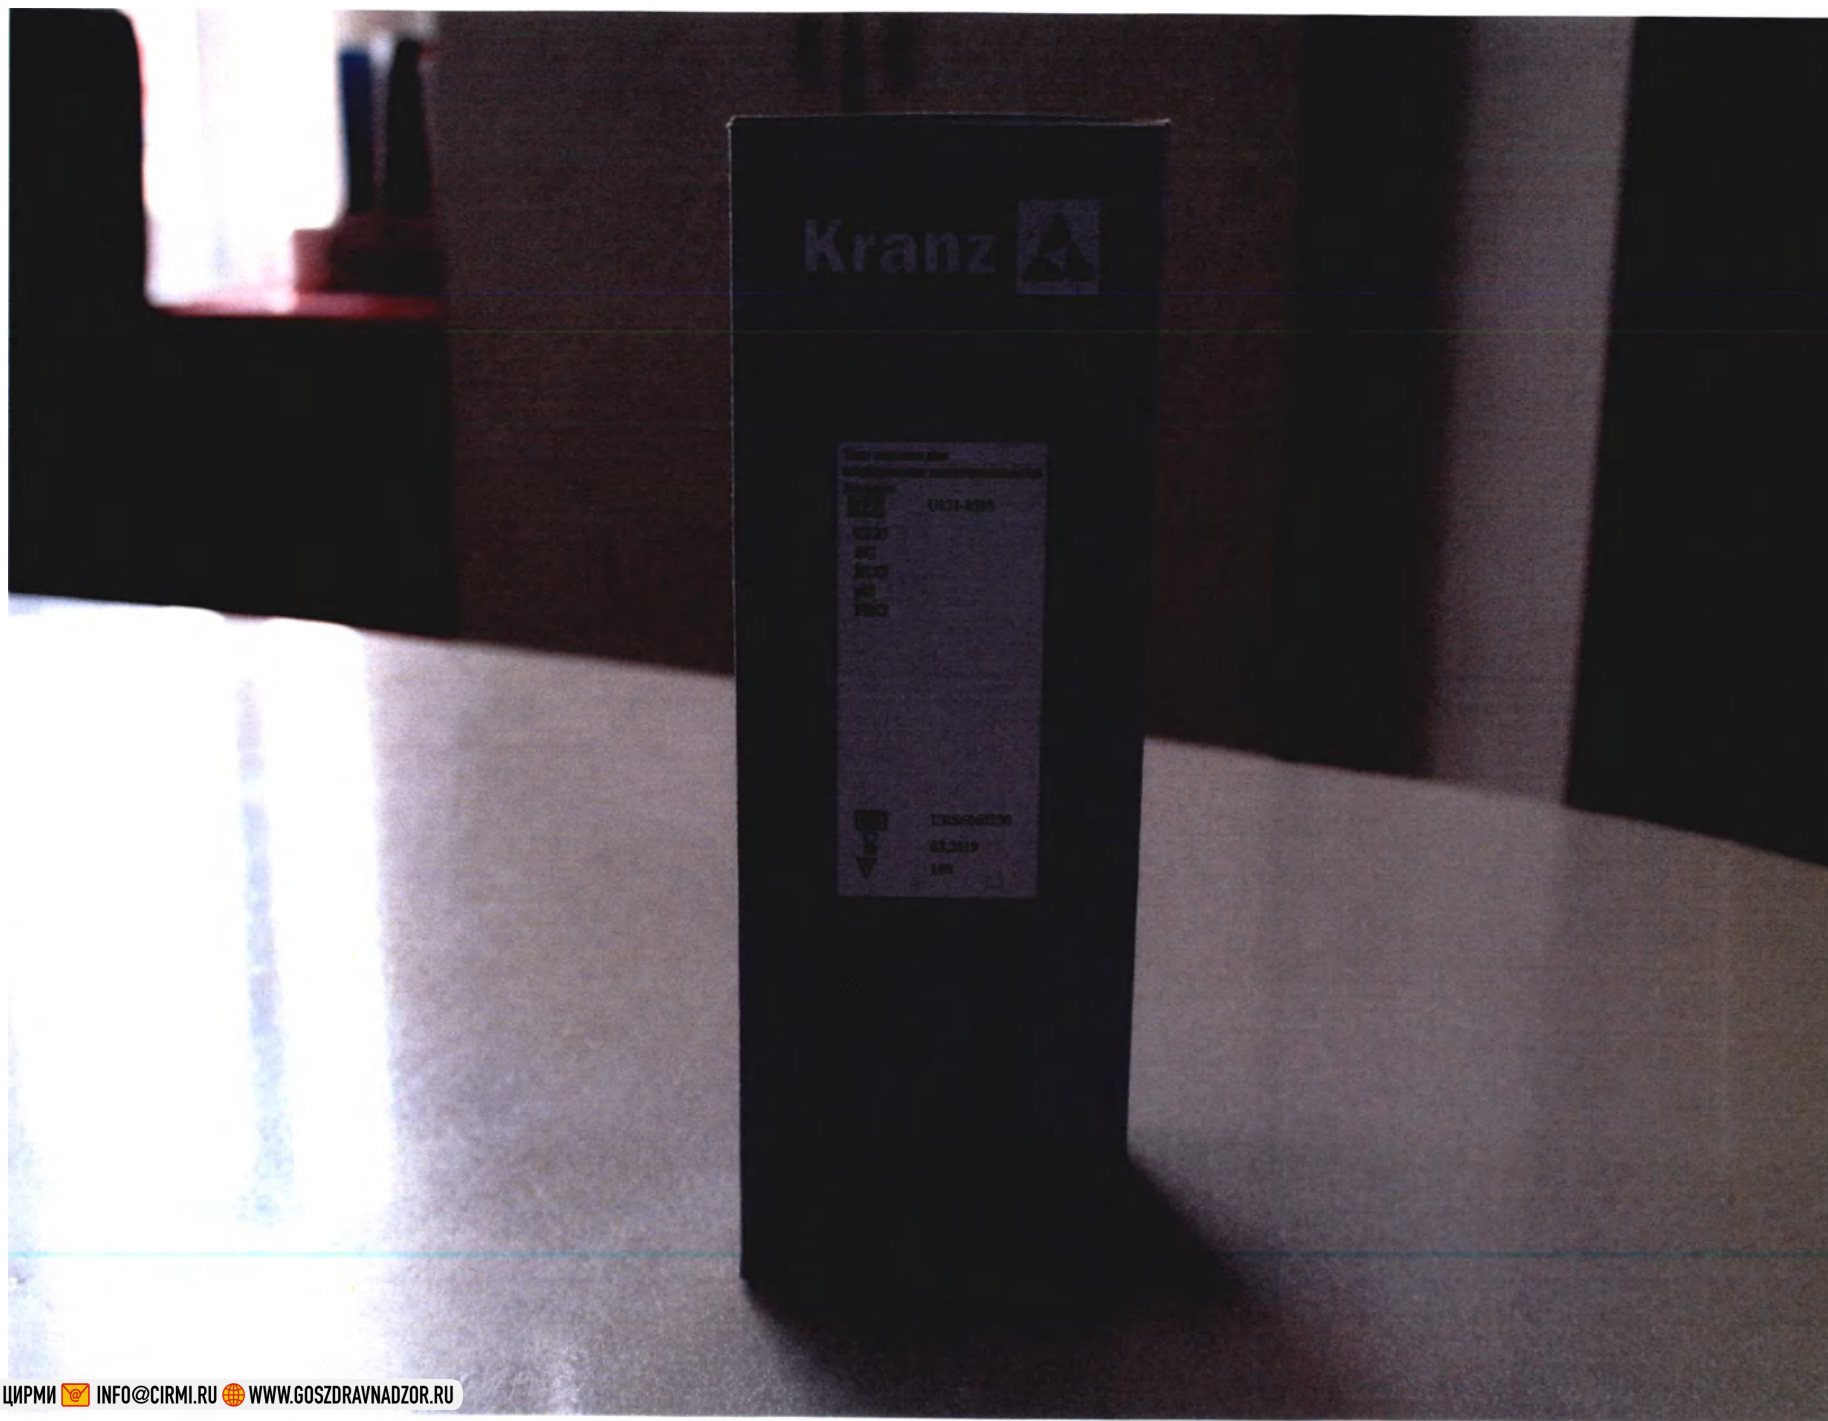

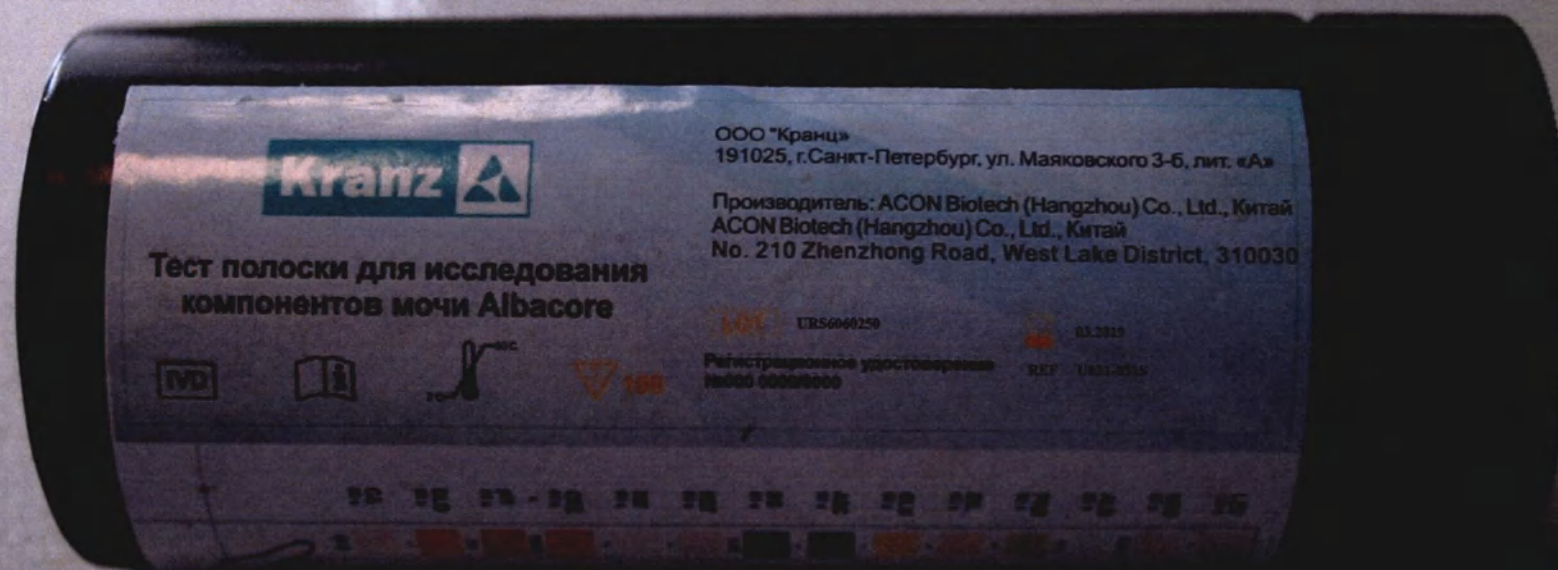


27. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore , 5 параметров (Глюкоза, Кровь, Белок, Нитриты, Лейкоциты) (GLU, BLO, PRO, NIT, LEU) U031-051N

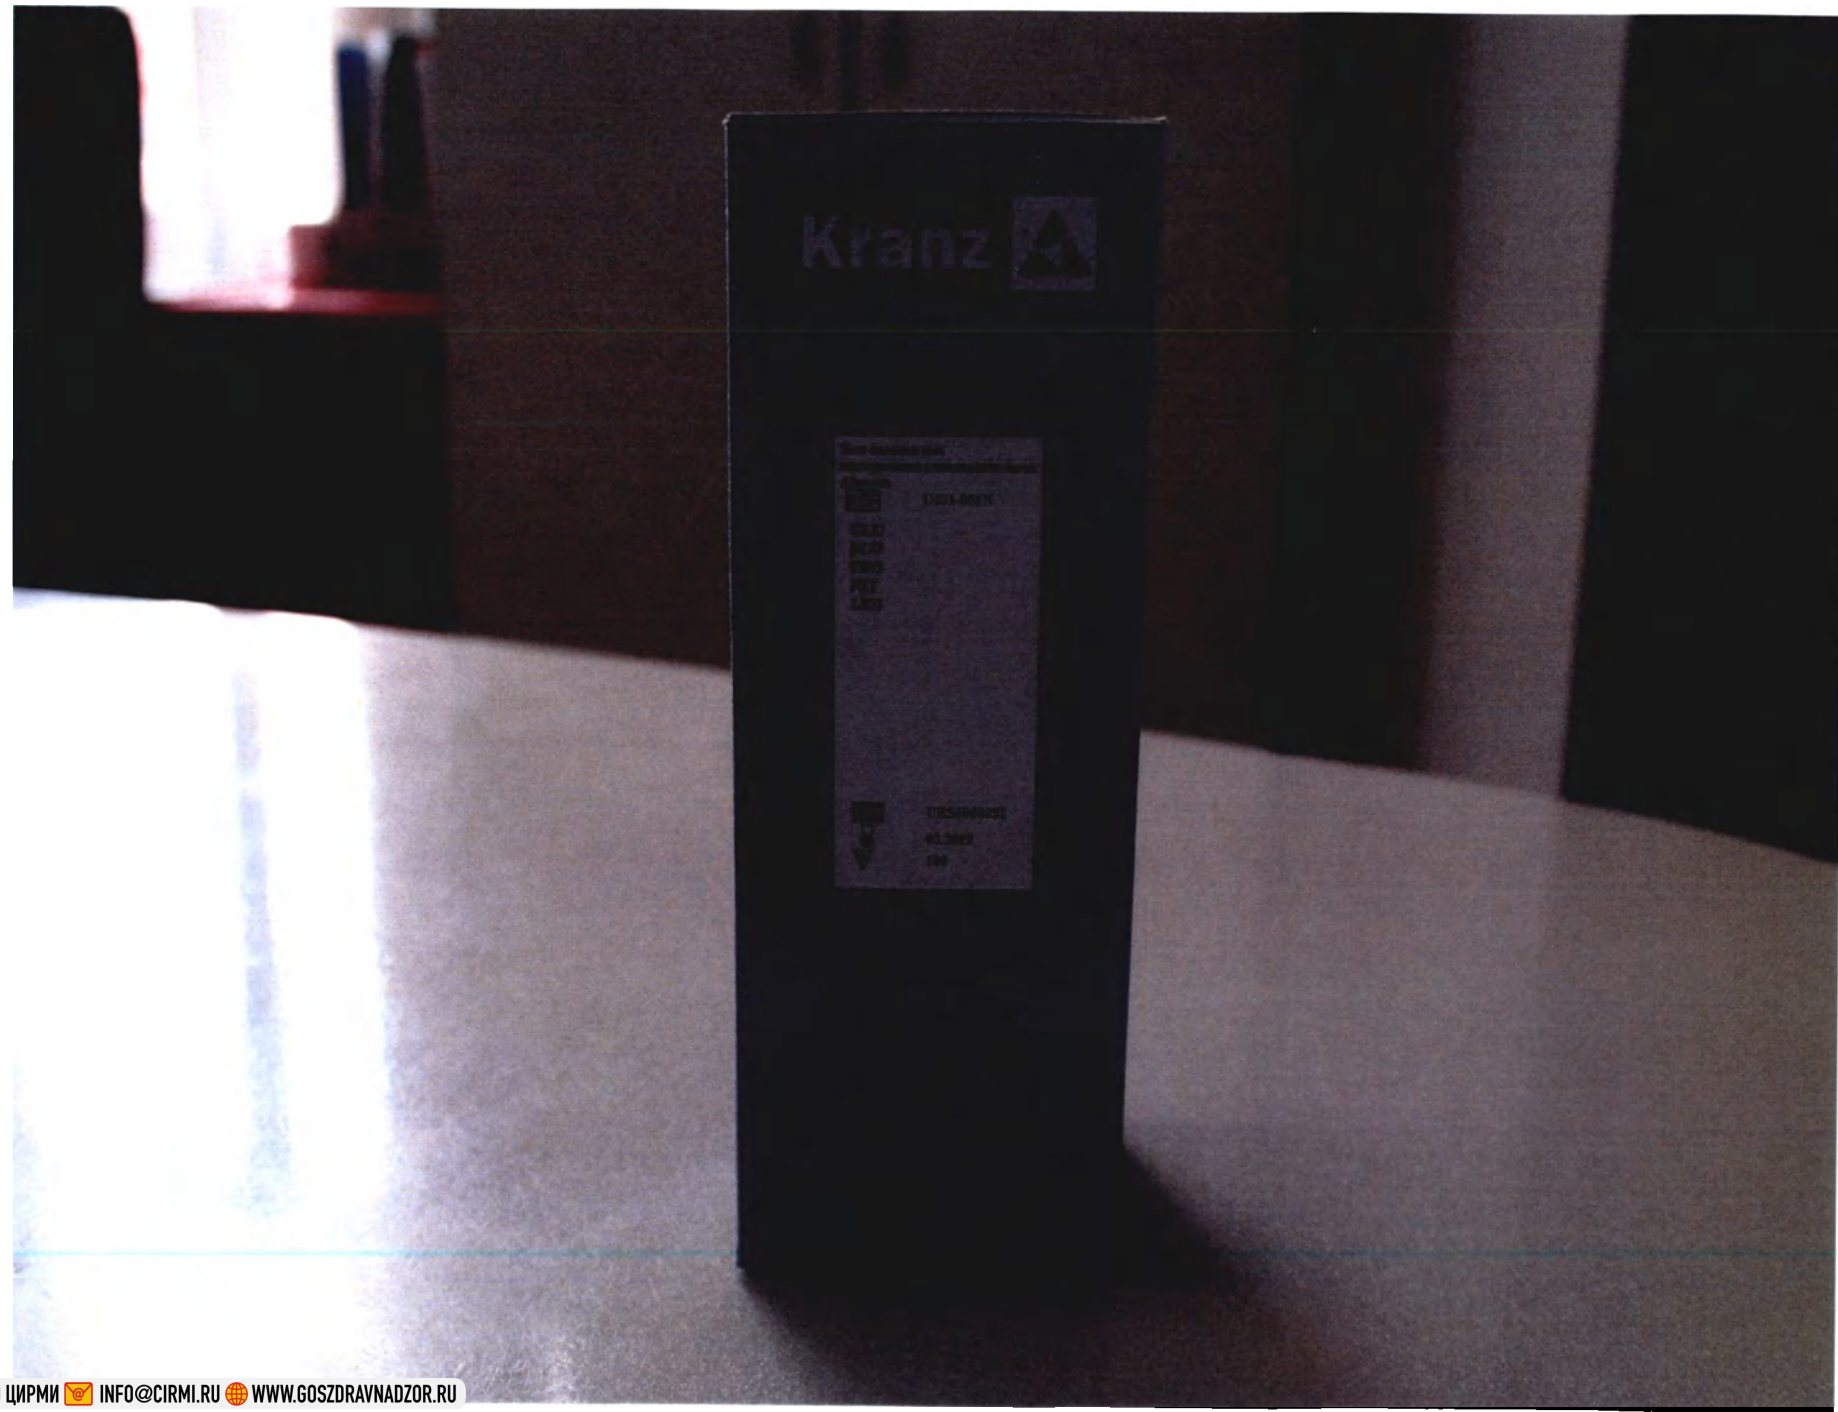

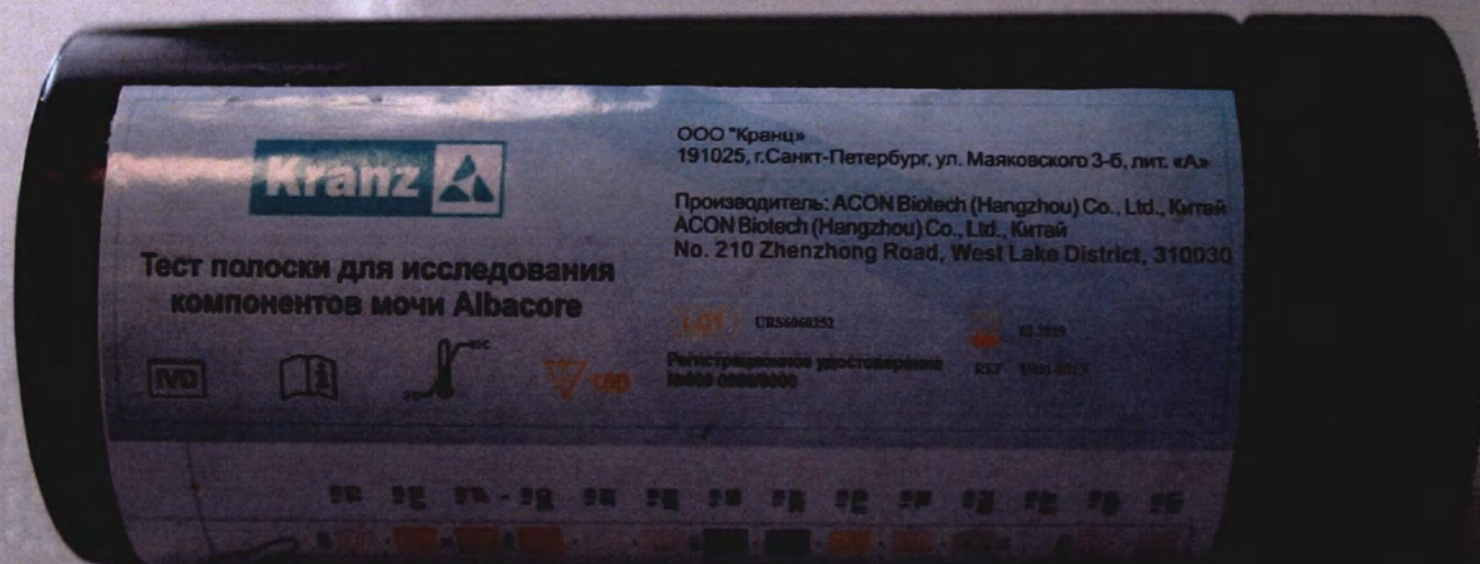


28. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore , 4 параметра (Глюкоза, Кровь, pH, Белок) (GLU, BLO, pH, PRO) U031-041B



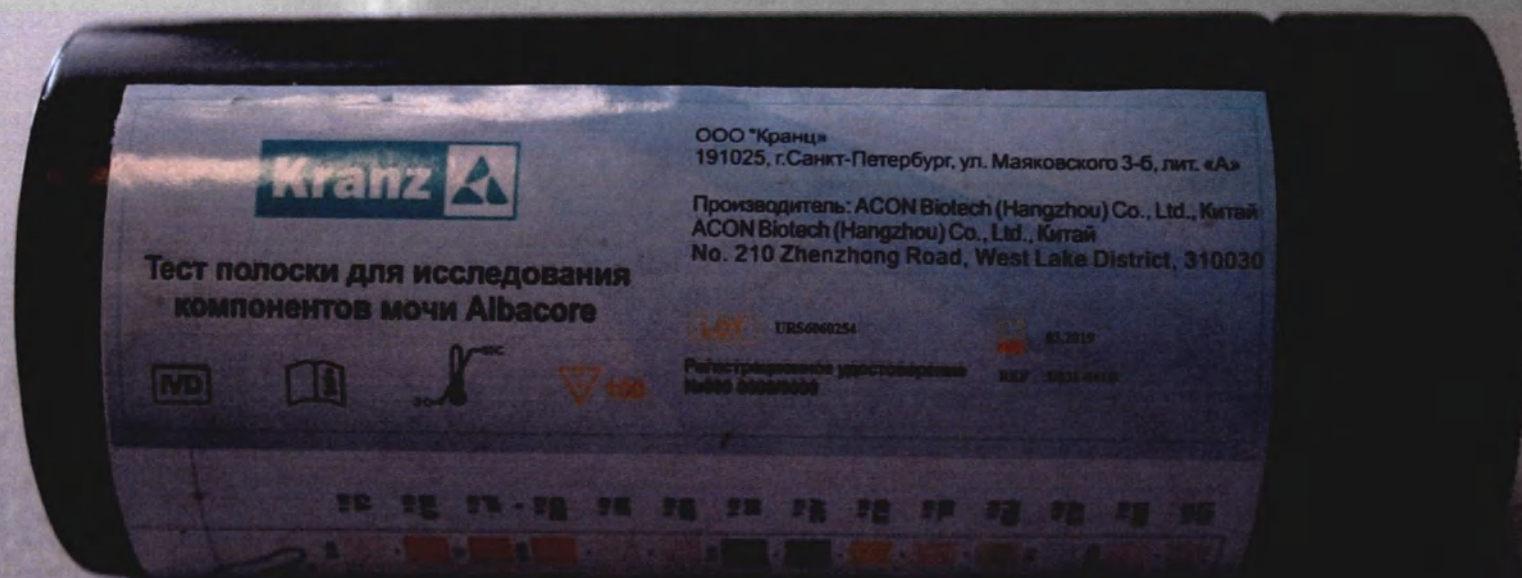


29. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, 4 параметра (Глюкоза, Удельный вес, pH, Белок) (GLU, SG, pH, PRO) U031-041S



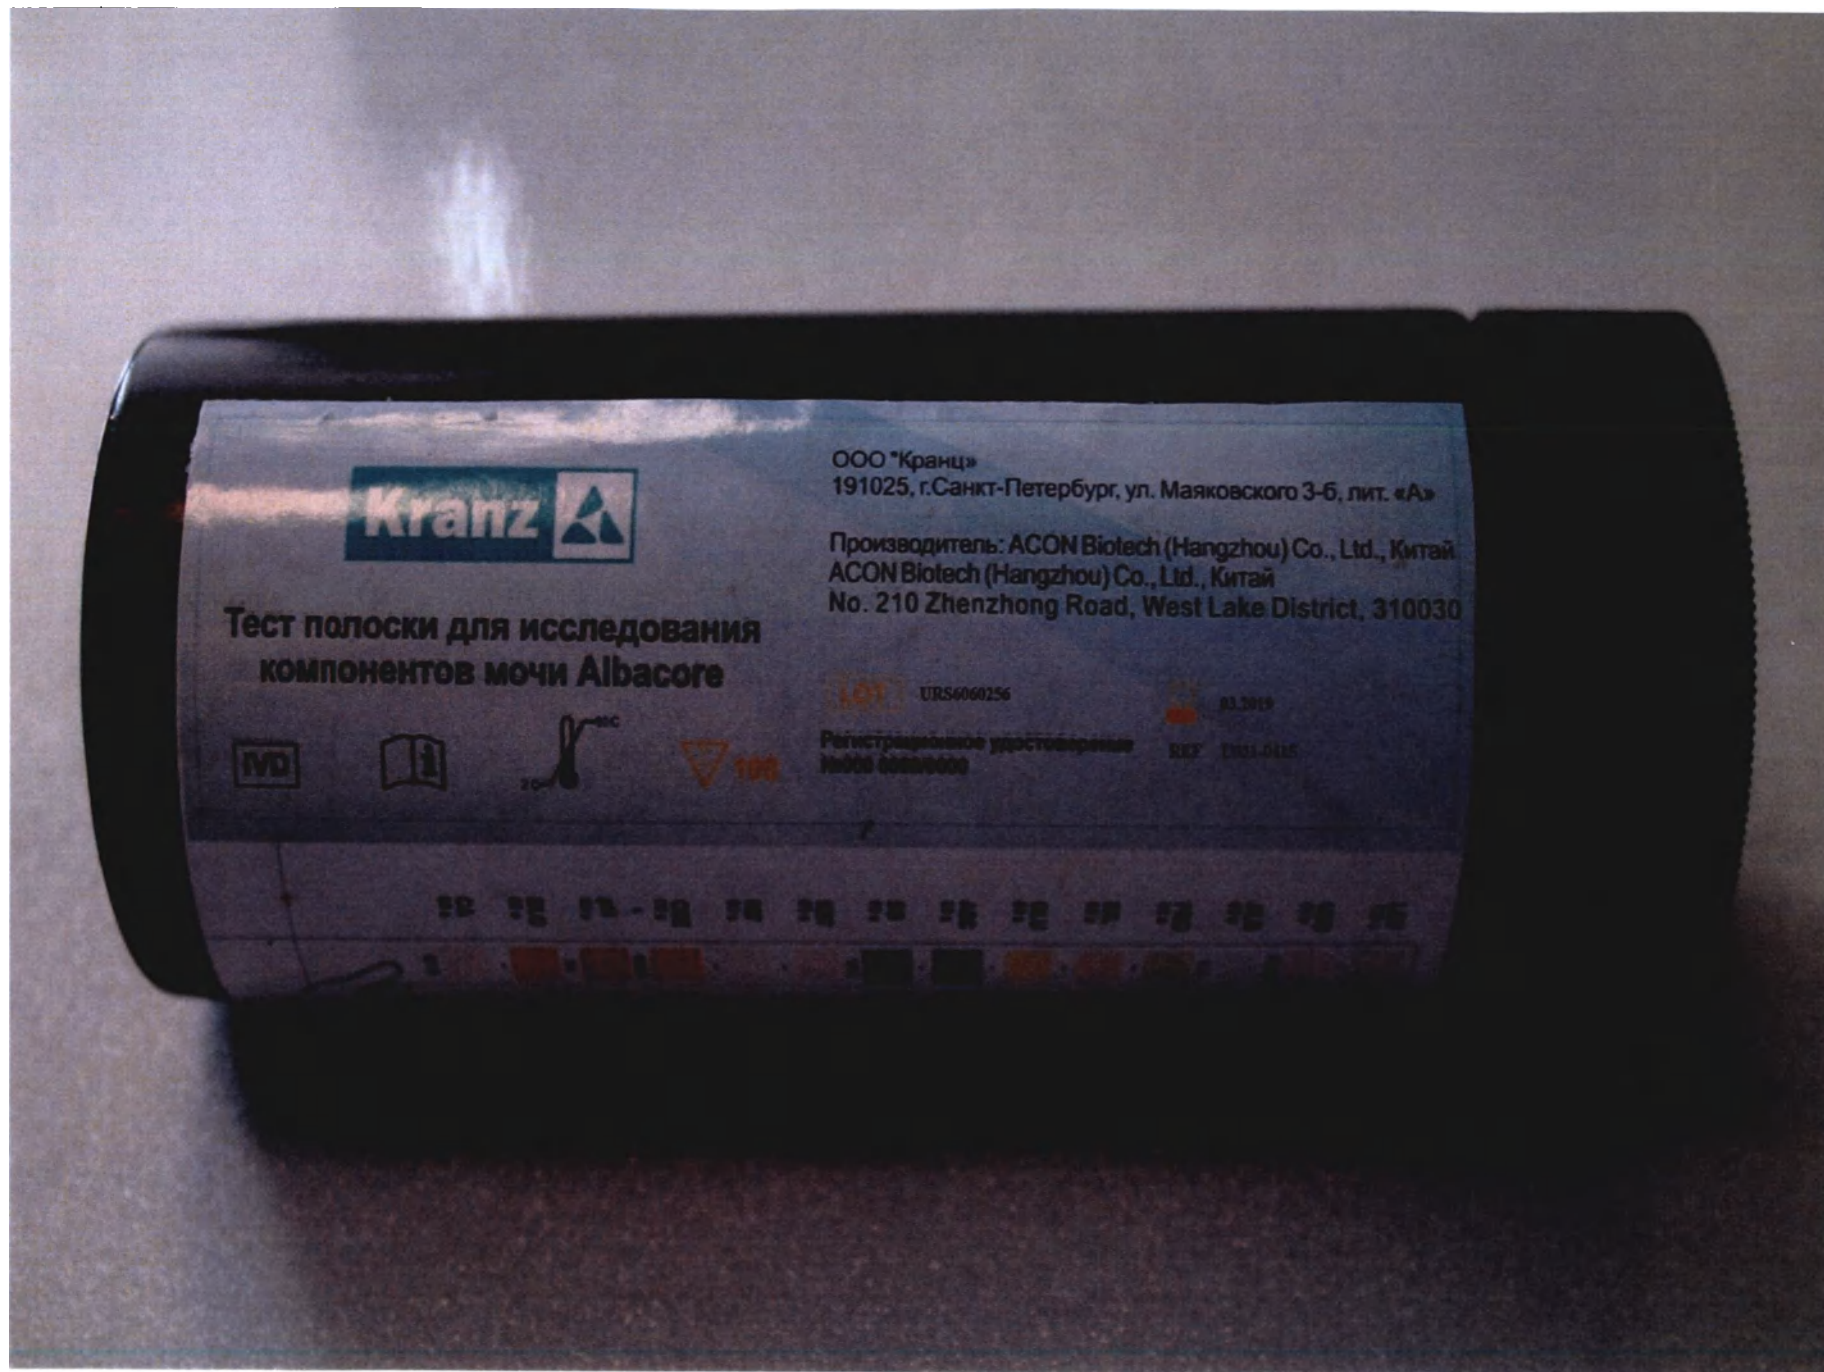

30. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, 4 параметра (Глюкоза, Белок, Нитриты, Лейкоциты) (GLU, PRO, NIT, LEU) U031-041P




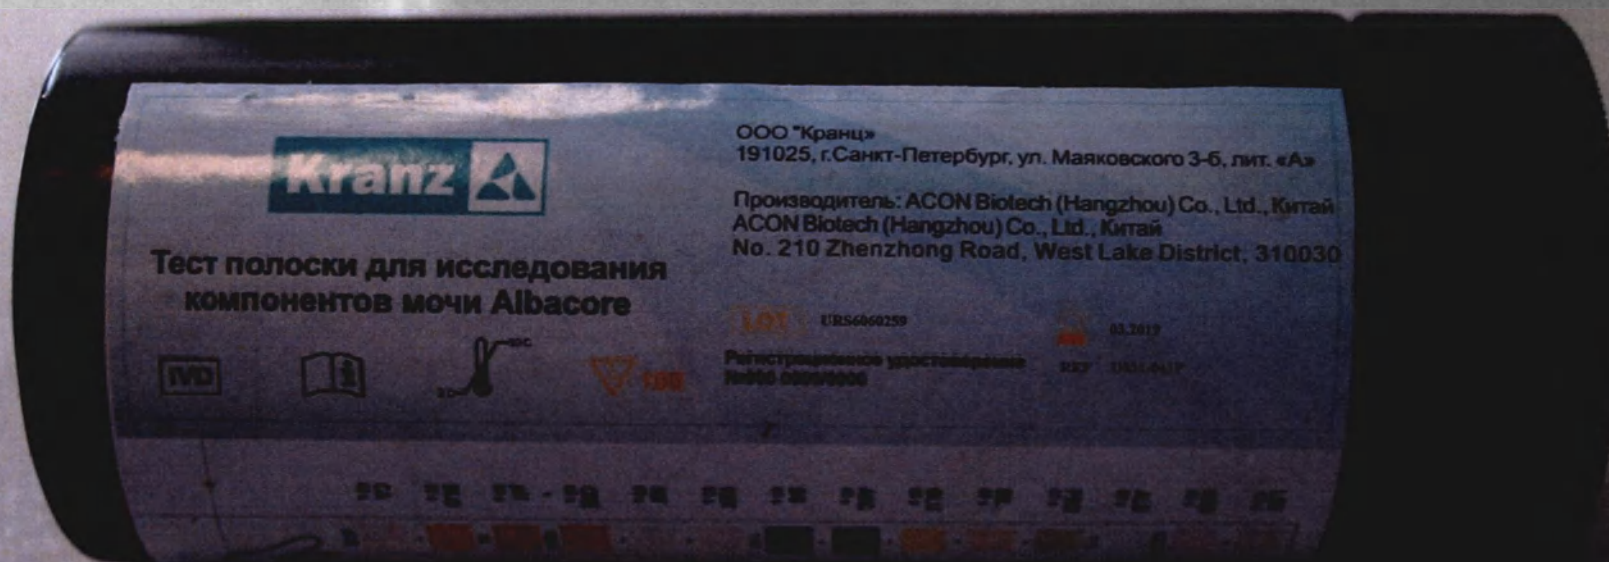

31. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, 4 параметра (Глюкоза, Кетоны, pH, Белок) (GLU, KET, pH, PRO) U031-041K

62




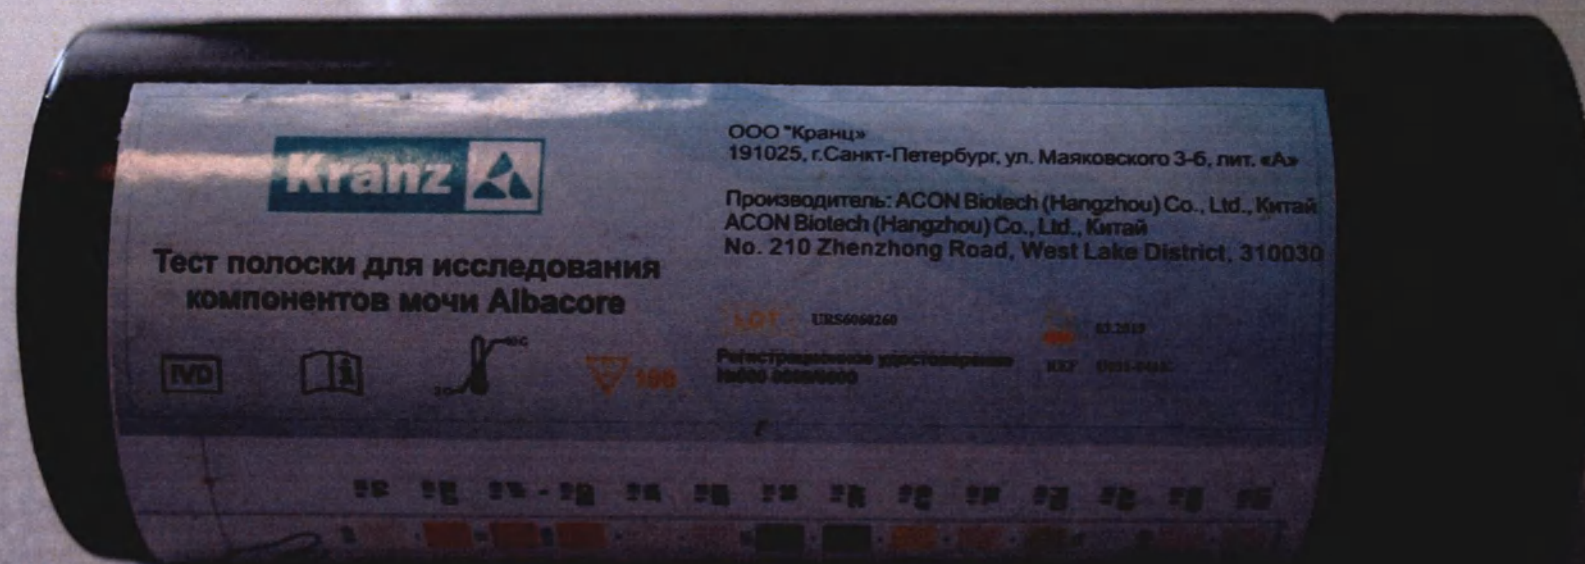

32. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, 4 параметра (Глюкоза, Кровь, Белок, Лейкоциты) (GLU, BLO, PRO, LEU) U031-041G

64




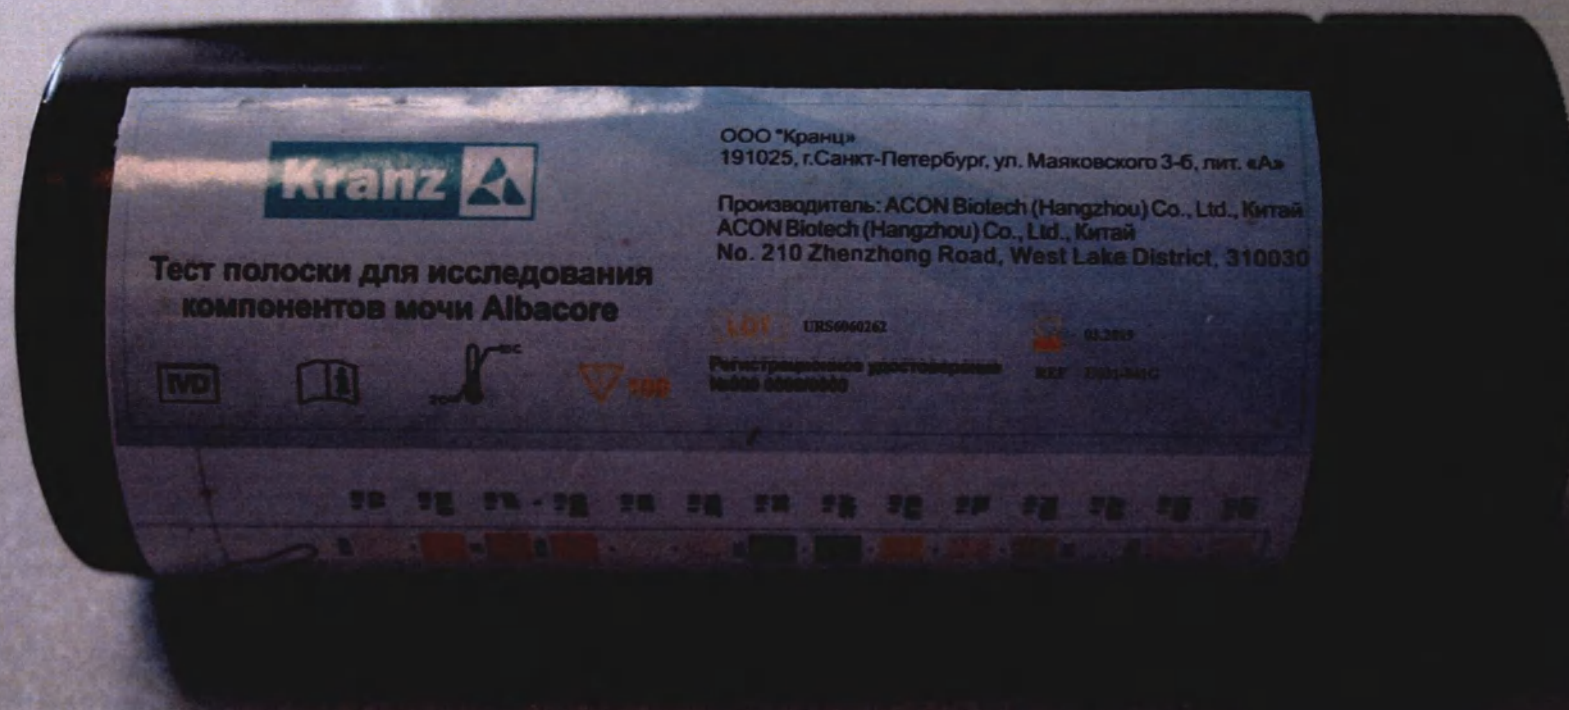

33. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, 4 параметра (Кровь, Белок, Нитриты, Лейкоциты) (BLO, PRO, NIT, LEU) U031-041N


66



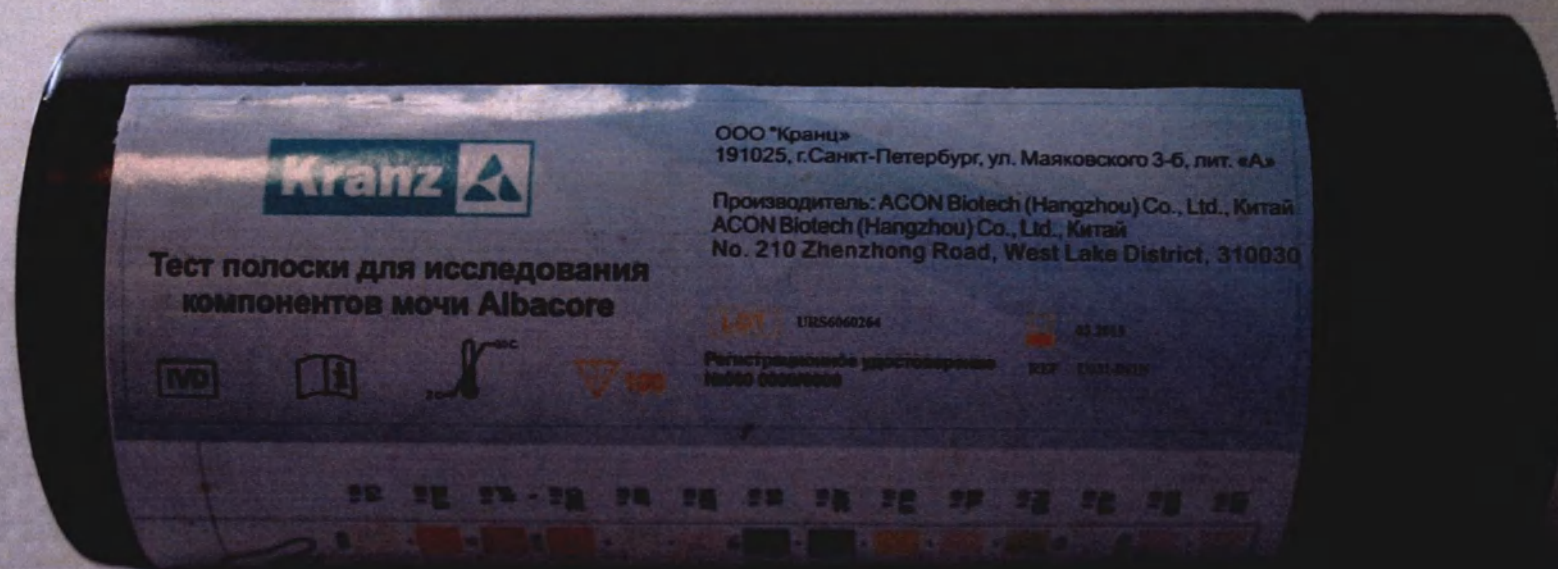

34. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, 3 параметра (Глюкоза, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Белок) (GLU, KET, PRO) U031-031P




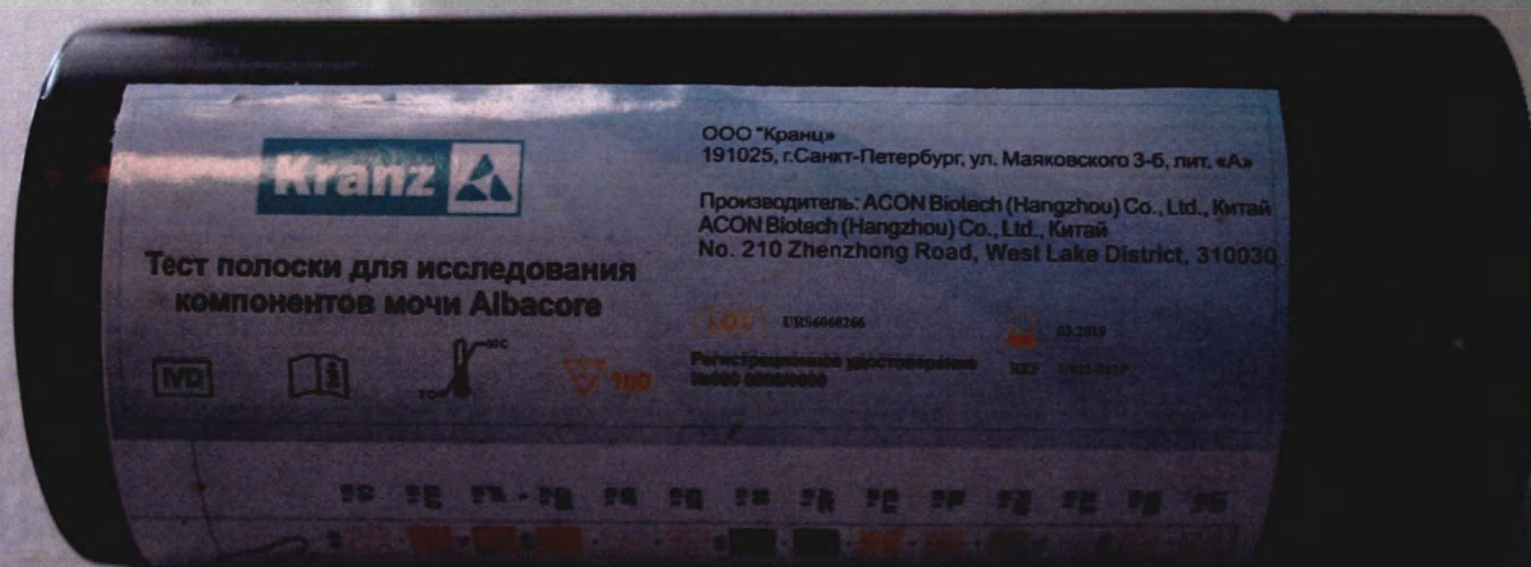

35. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, 3 параметра (Глюкоза, Кетоны (ацетоуксусная кислота), pH) (GLU, KET, pH) U031-031K

70



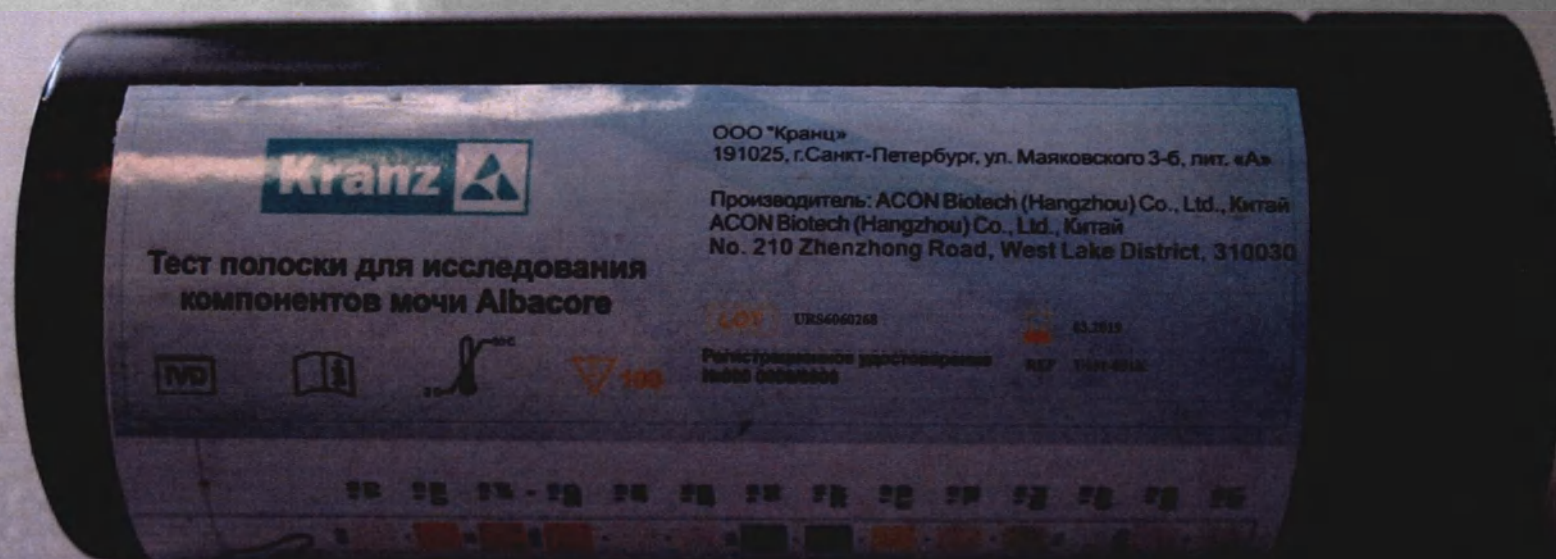

Тест полоски для исследования
компонентов мочи Albacore

ООО "Кранц"
191025, г.Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3-б, лит. «А»

Производитель: ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd., Китай
ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd., Китай
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District, 310030

LOT URS4060268

43.2819

Регистрационное удостоверение
№000 00000000


REF 1501-0010



36. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, 3 параметра (Кровь, Нитриты, Лейкоциты) (BLO, NIT, LEU) U031-031G

72



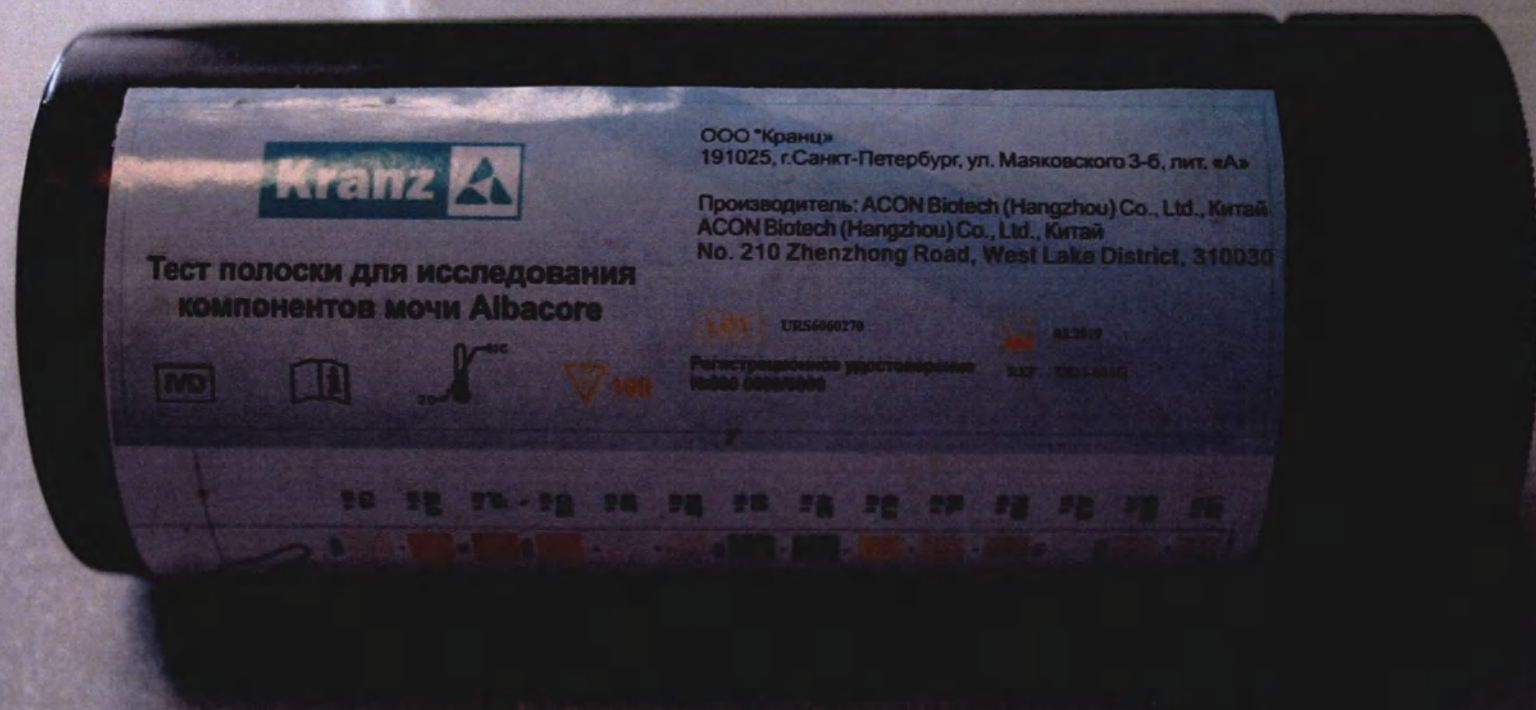

**Тест полоски для исследования
компонентов мочи Albacore**


ООО "Кранц"
191025, г.Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3-б, лит. «А»

Производитель: ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd., Китай
ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd., Китай
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District, 310030

URS6060270 02.2019
Регистрационное удостоверение
10000 00000000






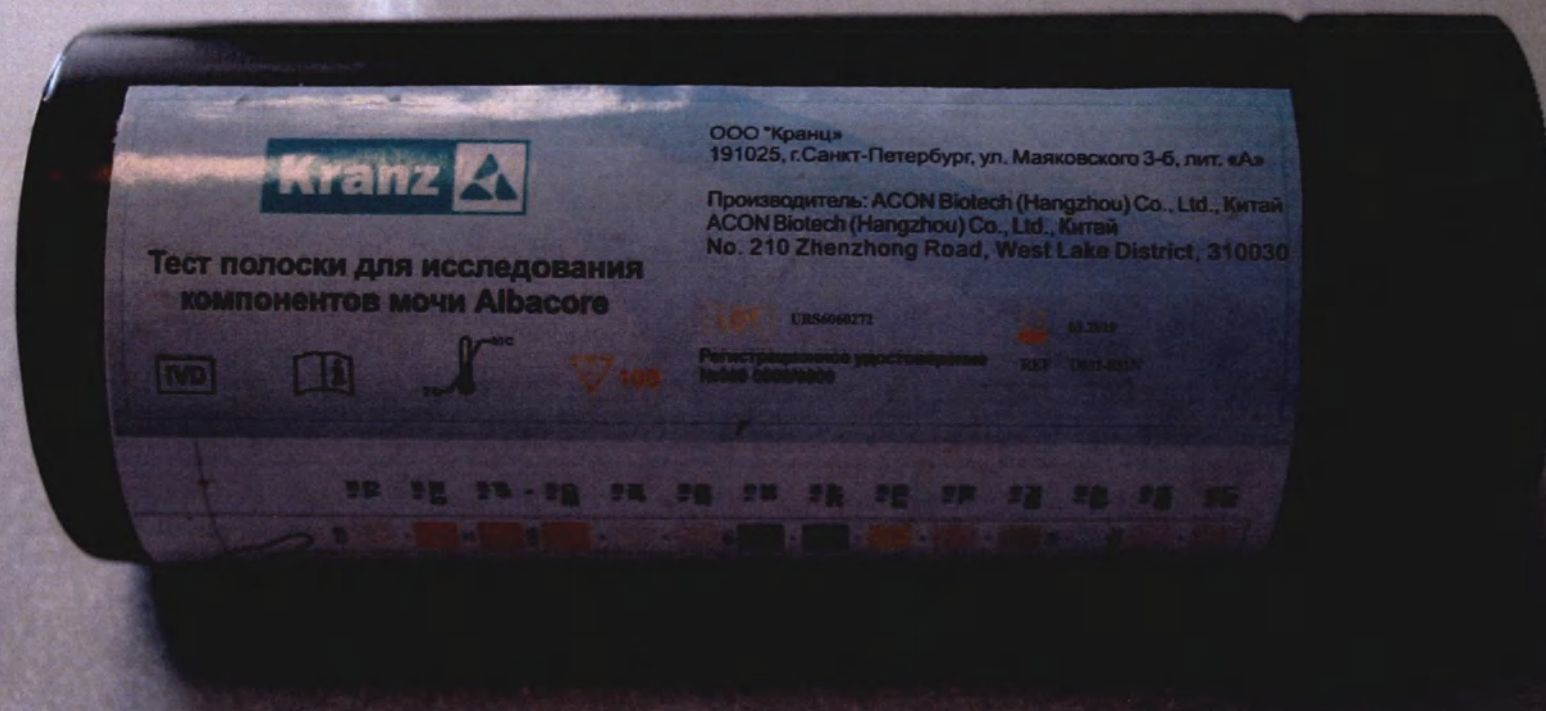


38. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, 3 параметра (Аскорбиновая кислота, Глюкоза, Кетоны (ацетоуксусная кислота)) (ASC, GLU, KET) U031-032A



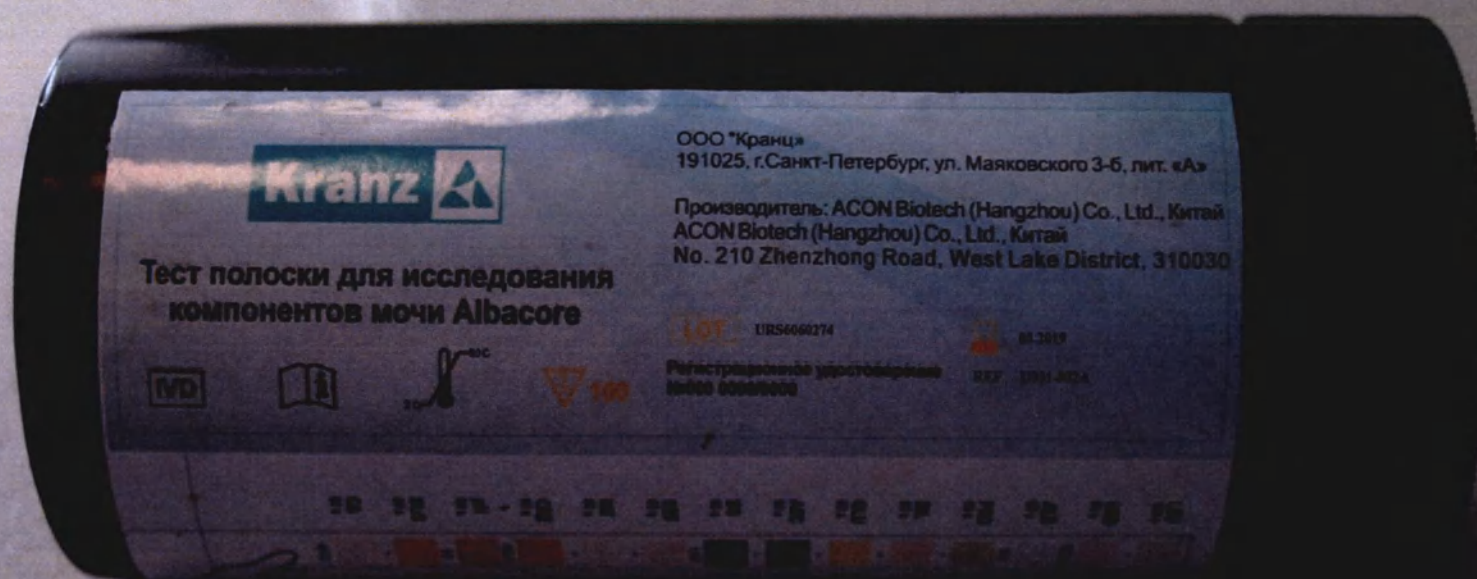




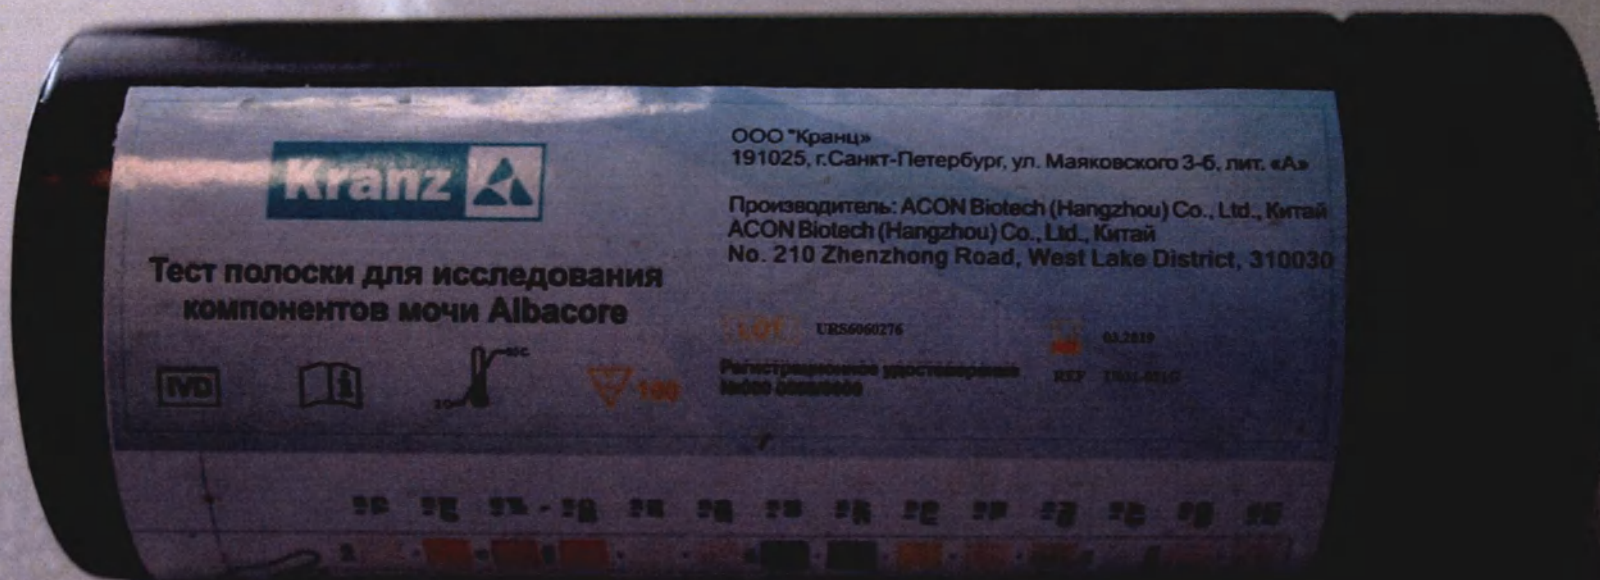


40. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, 2 параметра (Глюкоза, Кетоны (ацетоуксусная кислота)) (GLU, KET)
U031-021K

80



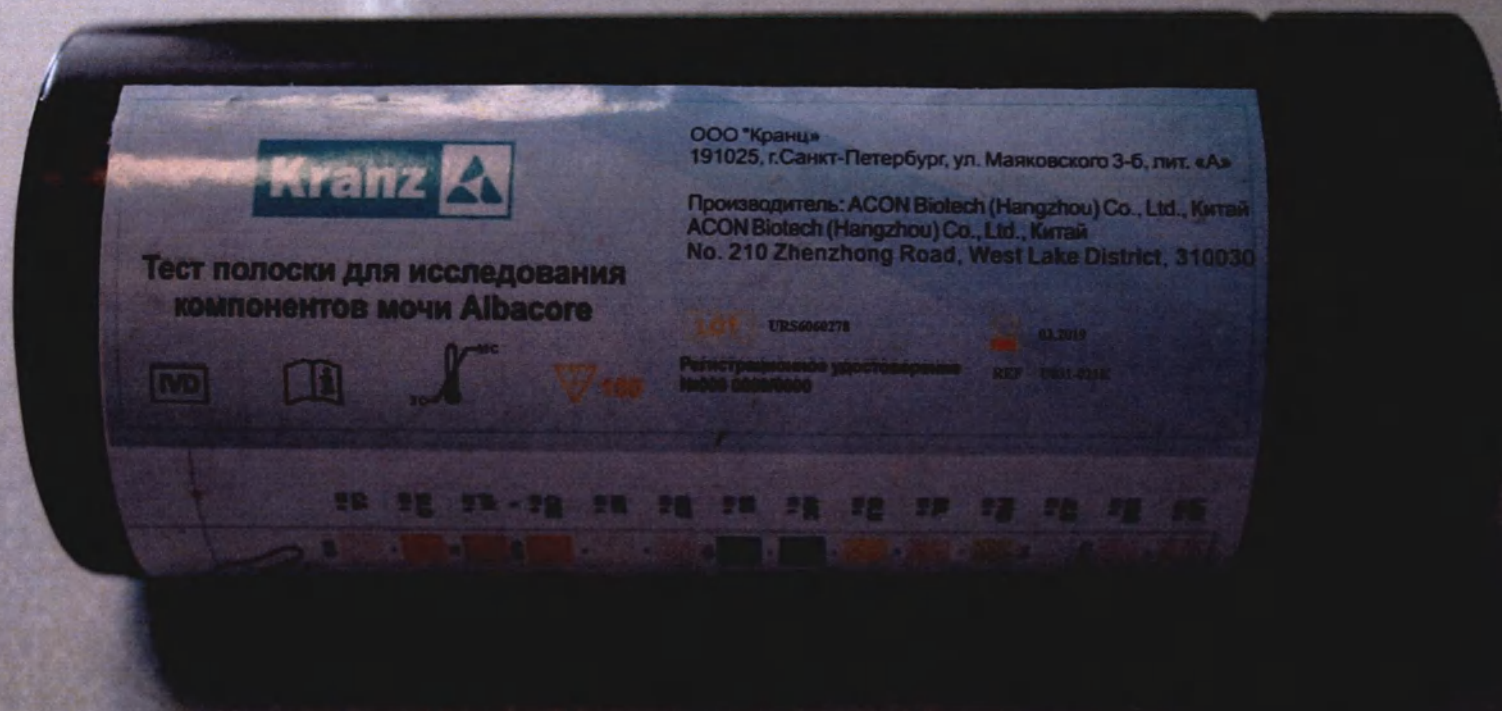




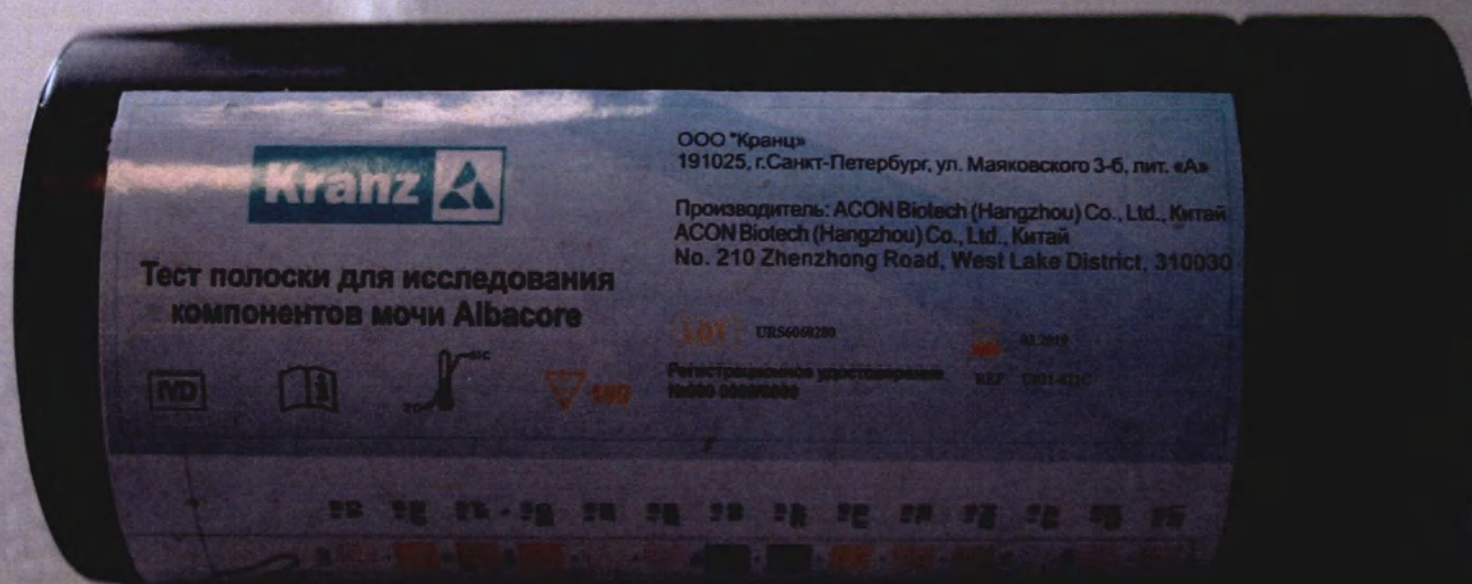


42. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, 2 параметра (Удельный вес, pH) (SG, pH,) U031-021S




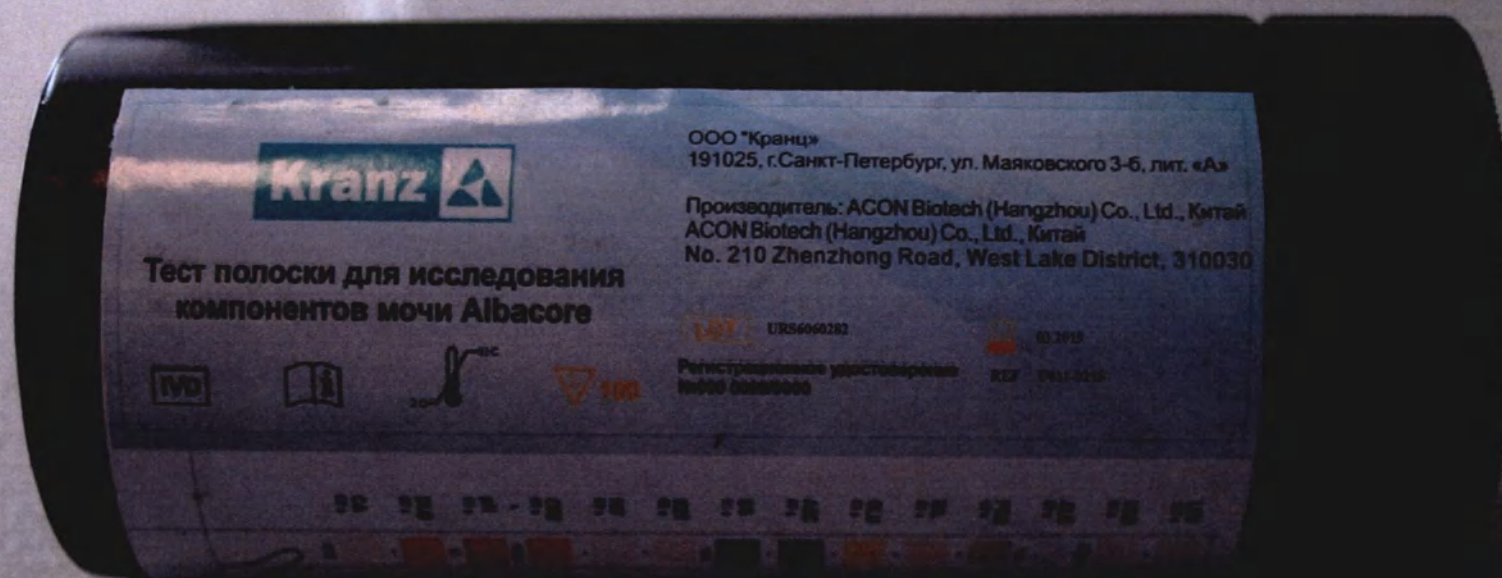




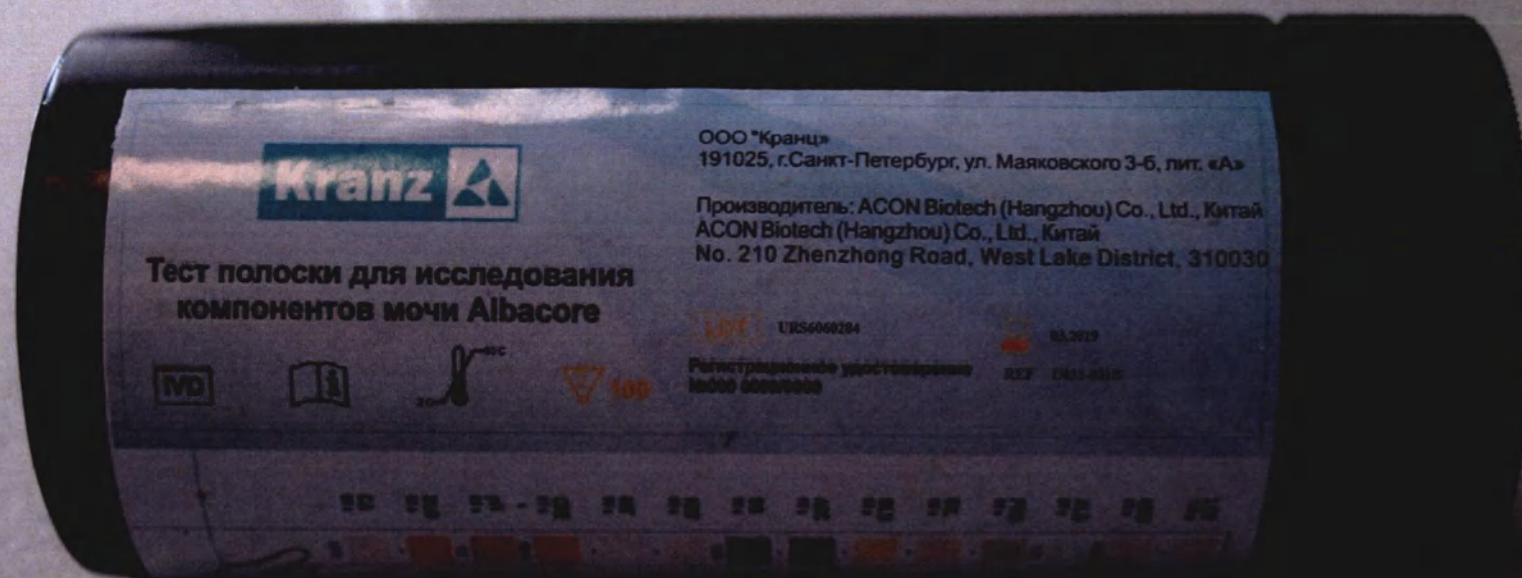




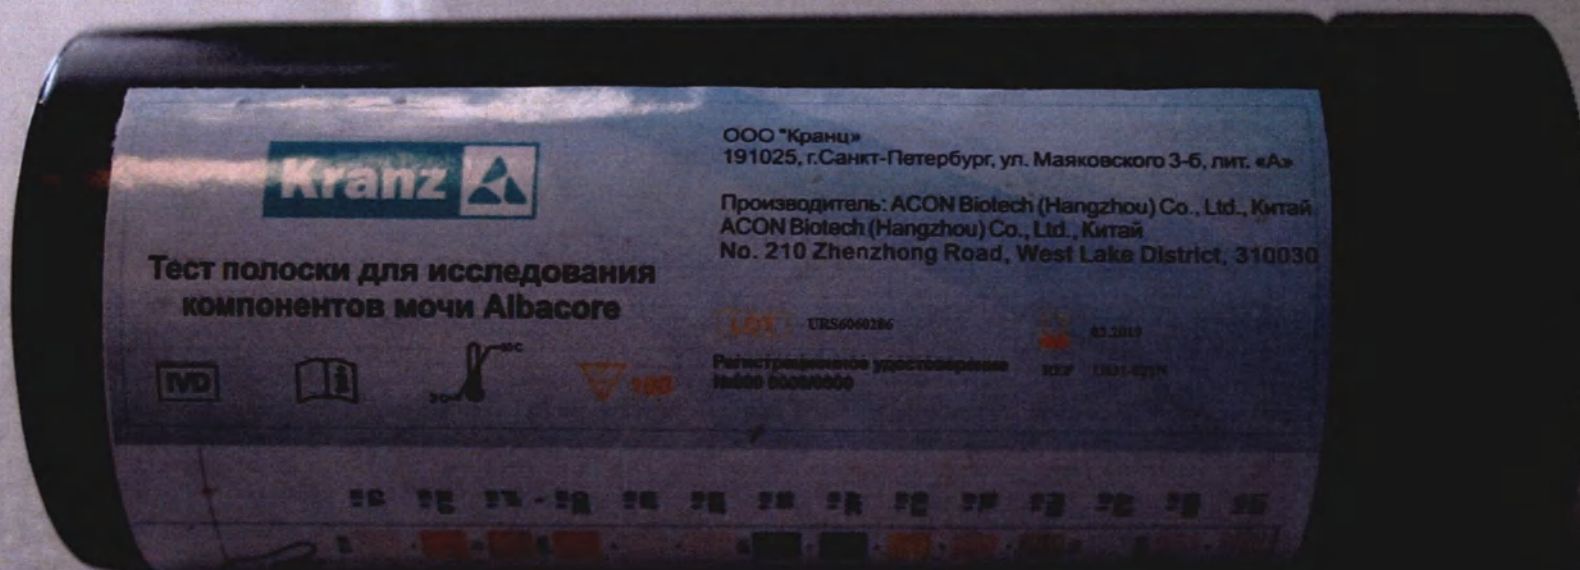




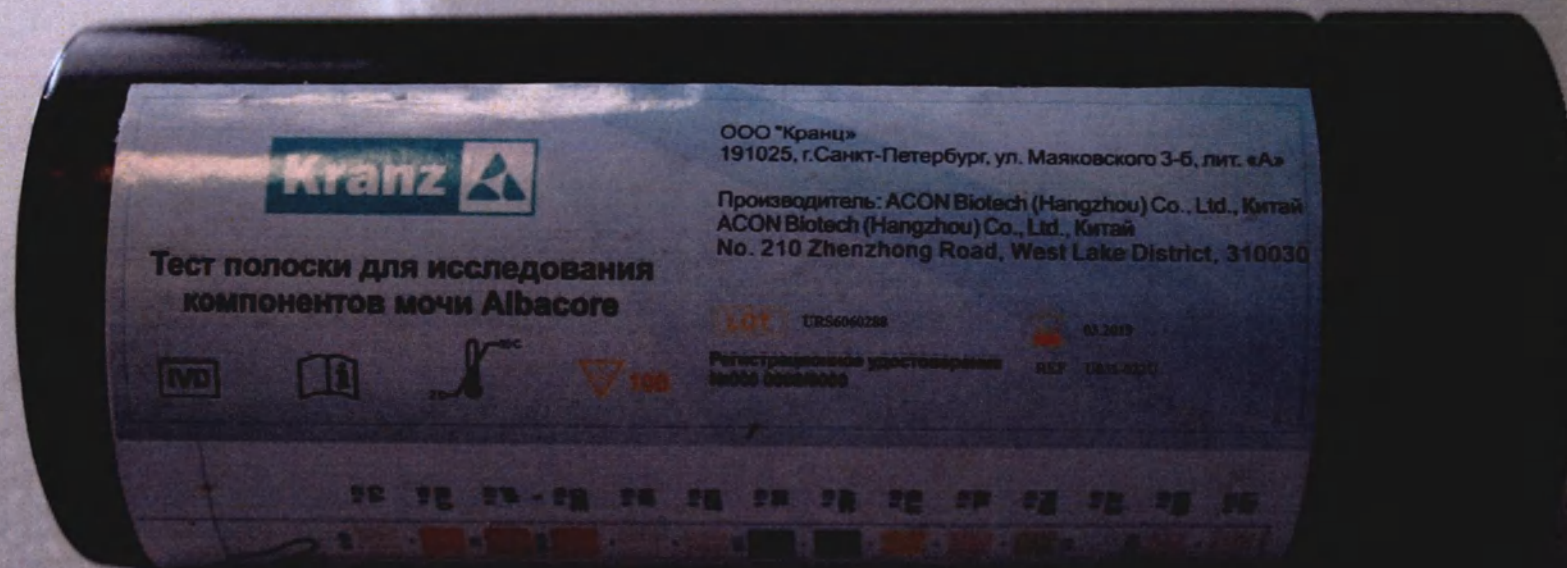



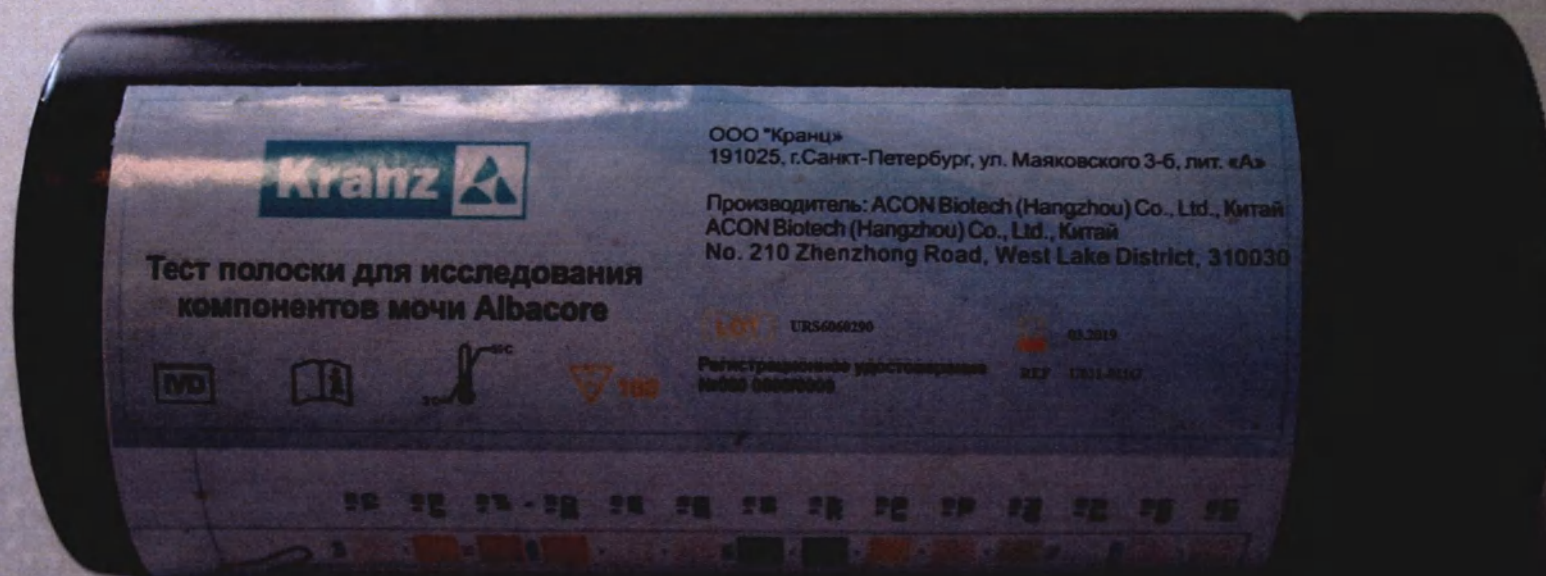



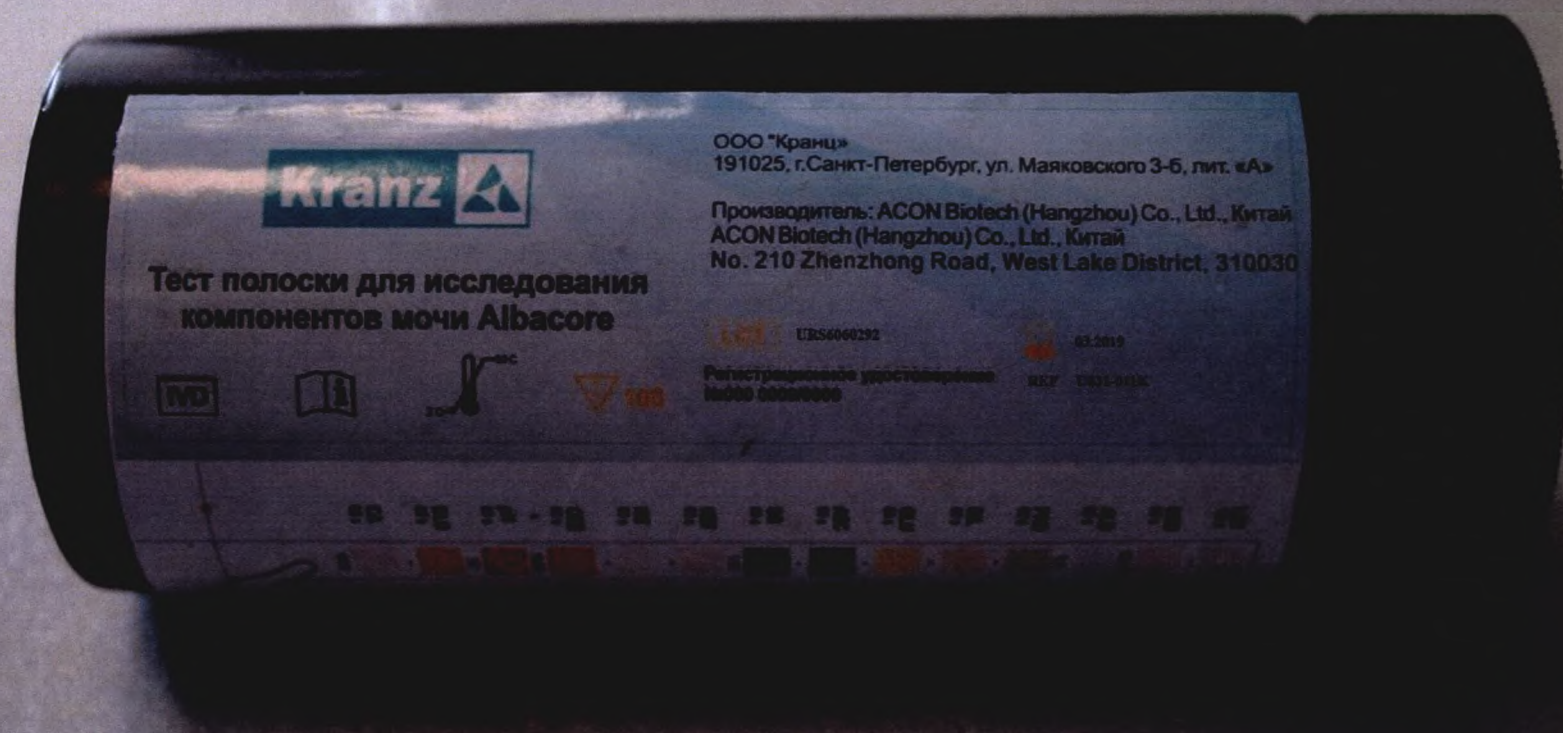


48. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore белка в моче (PRO) U031-011R






49. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore pH в моче (pH)U031-011P



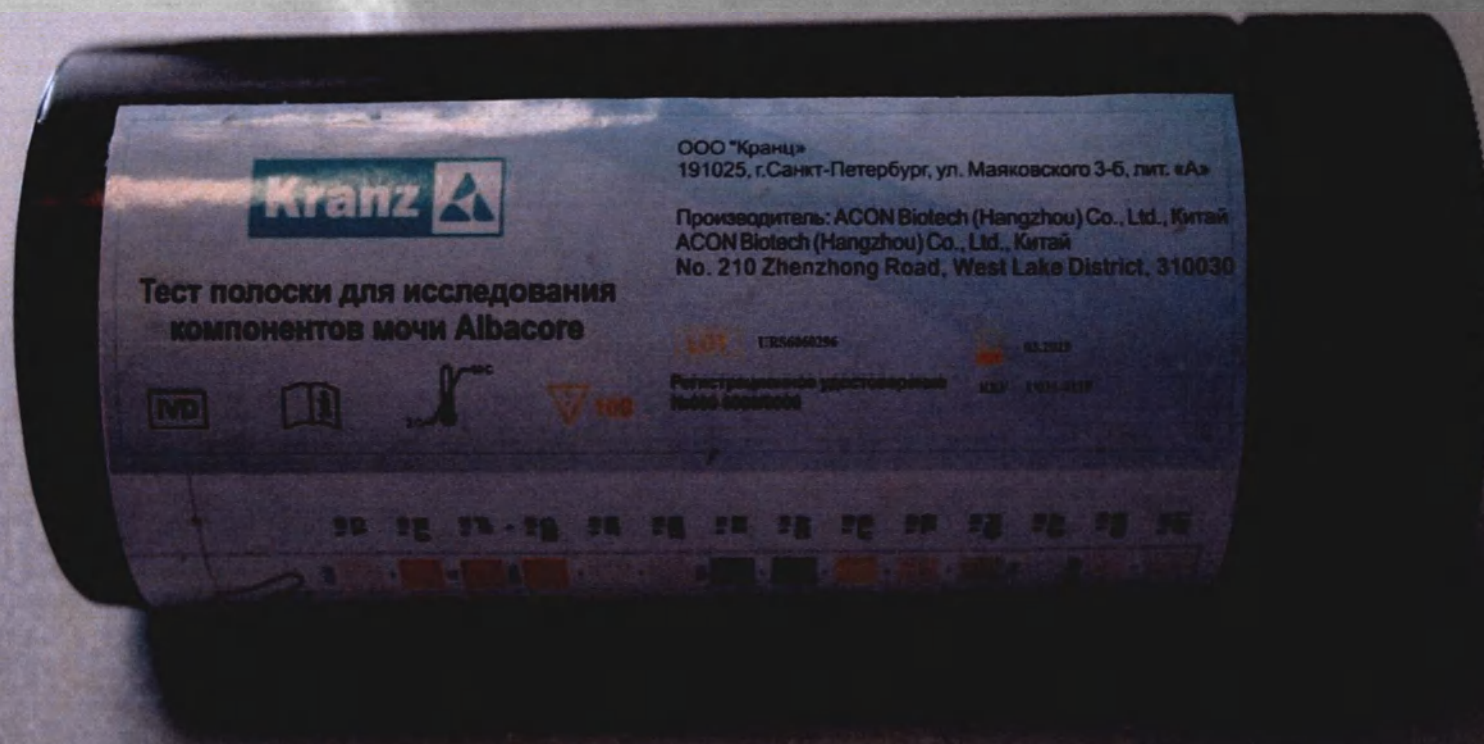

50. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore Крови в моче (BLO) U031-011B



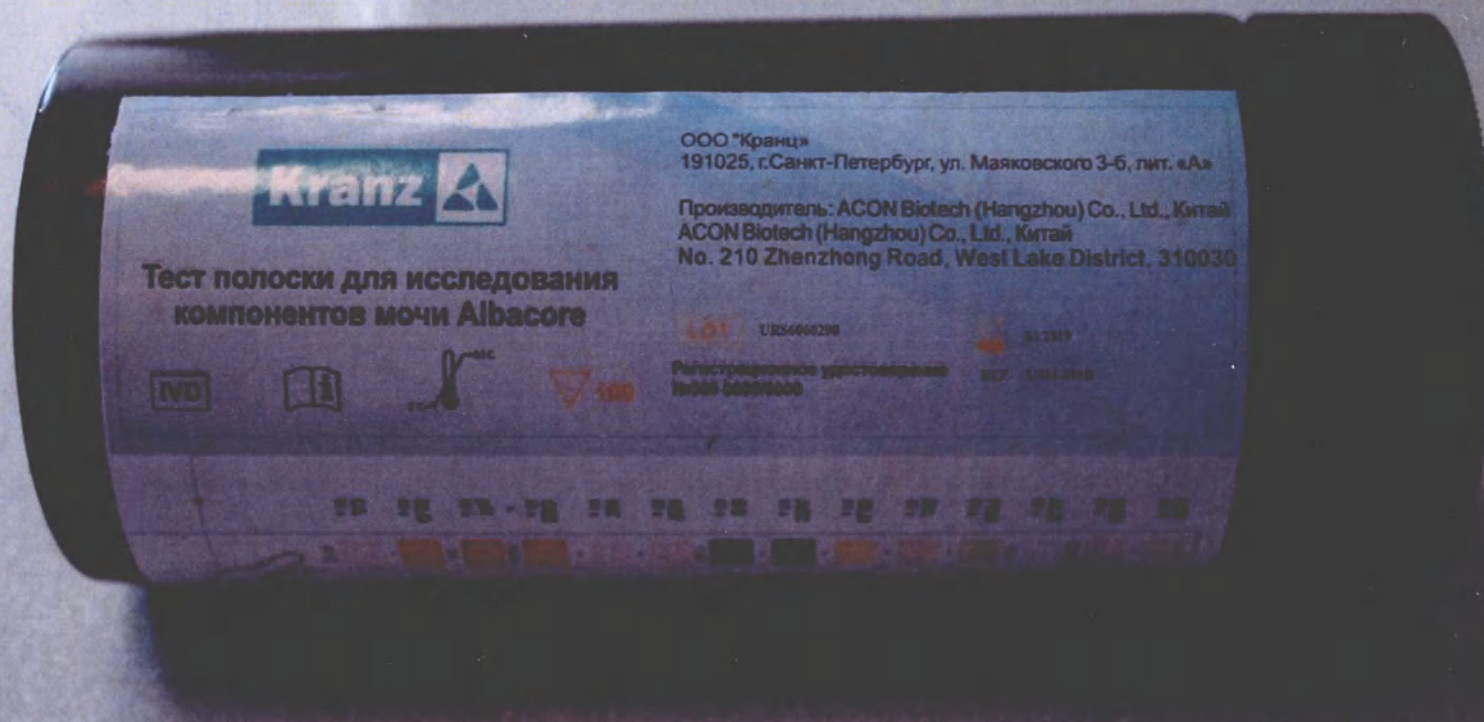

Прошито, пронумеровано на
104 листах

Директор Кузьмина И.В.

Кузьмина



ОКПД 2: 21.20.23.110

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Кранц»

И.В. Кузьмина

« 27 » февраля 2019 г.



МАКЕТ УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore
производства фирмы Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Китай

2019

Kranz 

■ Тест полоски, 100 шт

IVD



Kranz 

Тест полоски для исследования компонентов мочи Albacore

14 параметров (Аскорбиновая кислота, Глюкоза, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Удельный вес, Кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты, Альбумин, Креатинин, Кальций)

IVD

Kranz 

Тест полоски для исследования компонентов мочи Albacore

14 параметров (Аскорбиновая кислота, Глюкоза, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Удельный вес, Кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты, Альбумин, Креатинин, Кальций)

ASC
GLU
BIL
KET
SG
BLO
pH
PRO
URO
NIT
LEU
ALB
CRE
Ca

REF U031-141C

LOT URS6060200

03.2019




ООО «Кранц»
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского
3-б, лит. «А»

Производитель:
ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd., Китай
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District,
310030 Hangzhou, China

Kranz 

Регистрационное удостоверение
№000 0000/0000

IVD

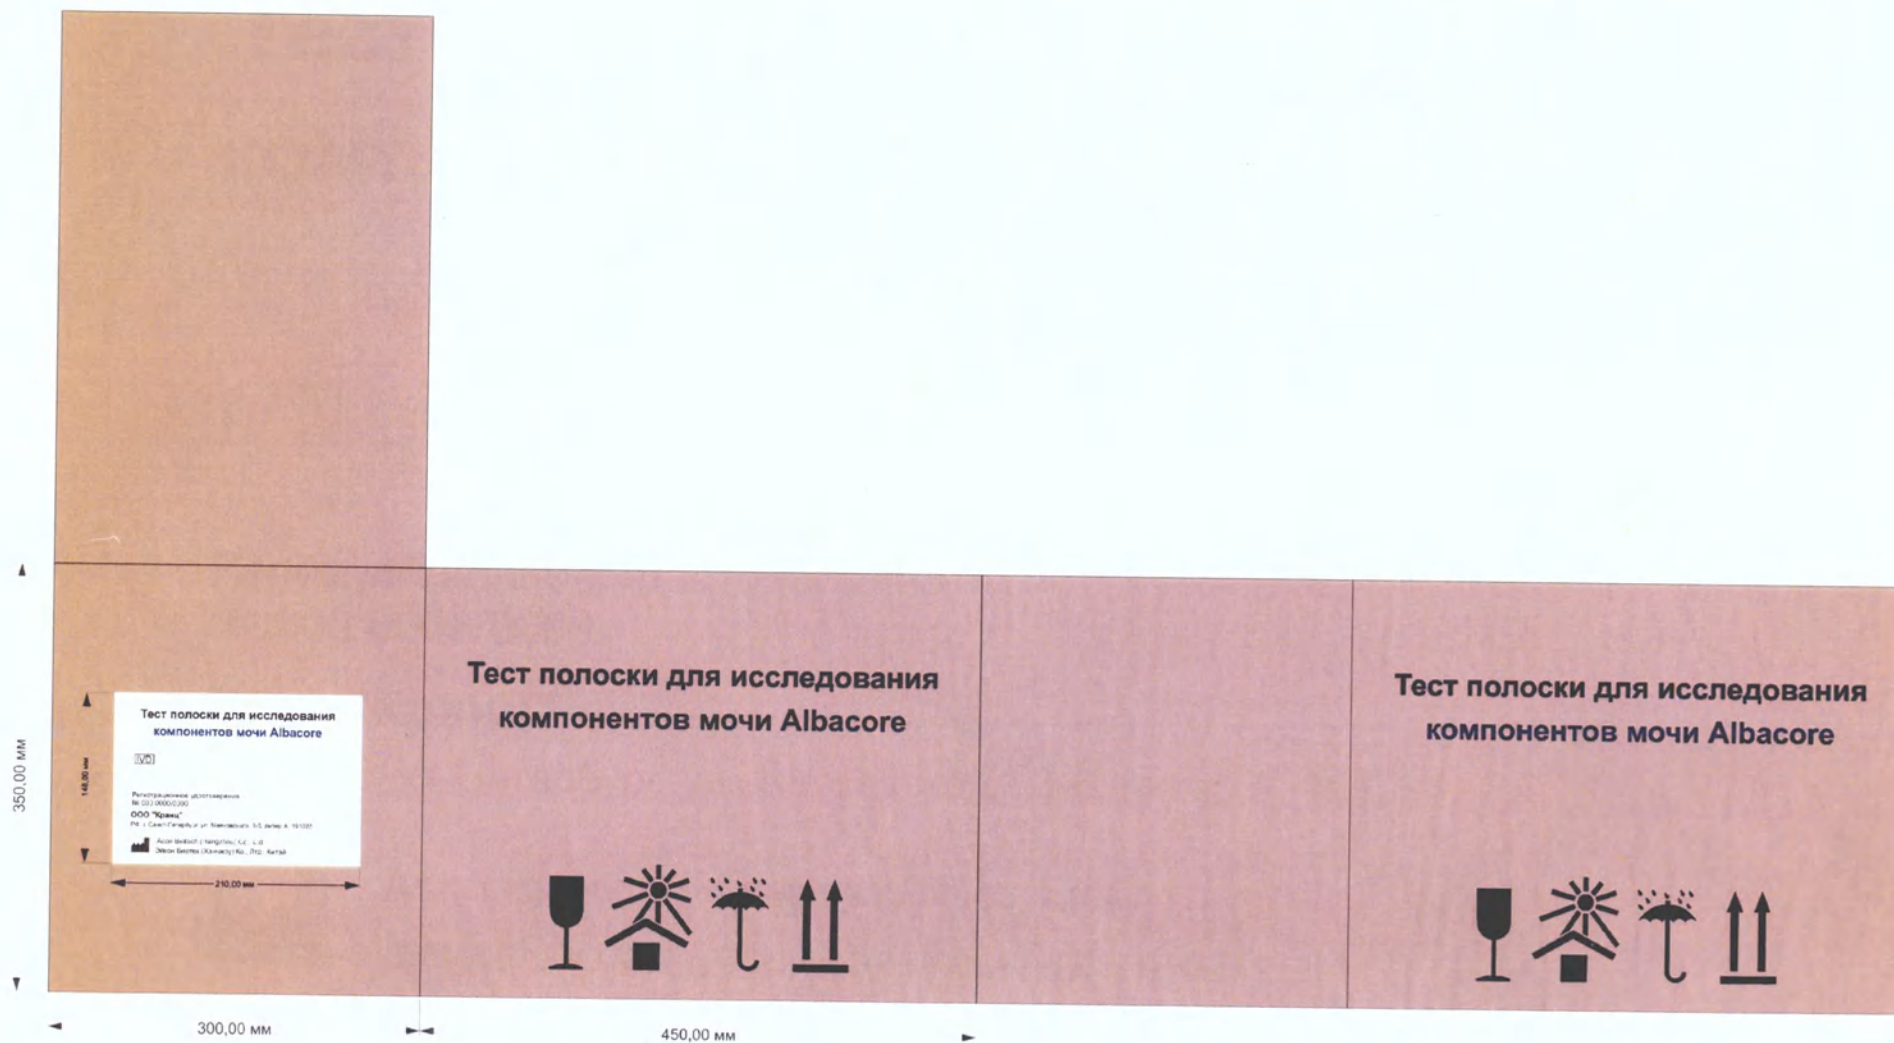

Тест полоски для исследования компонентов мочи Albacore U500

IVD

Регистрационное удостоверение
№ 000 0000/0000

ООО "Кранц"

РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 3-б, литер А, 191025



Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.

Эйкон Биотех (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай

Прошито, пронумер

4 листах

Директор Кузьмин

Кузьмин



ОКПД 2: 21.20.23.110

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Кранц»

И.В. Кузьмина

« 27 » февраля 2019 г.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore
производства фирмы Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Китай

2019

Kranz

Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, 14 параметров (Аскорбиновая кислота, Глюкоза, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Удельный вес, Кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты, Альбумин, Креатинин, Кальций) (ASC, GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU, ALB, CRE, Ca)

REF U031-141C LOT URS6060200 2019-03

Регистрационное удостоверение №000 0000/0000

Производитель: ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd., Китай
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District, 310030 Hangzhou, China

391025, г.Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3-б, лит. «А»

Kranz

Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, 14 параметров (Аскорбиновая кислота, Глюкоза, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Удельный вес, Кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты, Альбумин, Креатинин, Кальций) (ASC, GLU, BIL, KET, SG, BLO, pH, PRO, URO, NIT, LEU, ALB, CRE, Ca)

REF U031-141C LOT URS6060201 2019-03

Регистрационное удостоверение №000 0000/0000

Производитель: ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd., Китай
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District, 310030 Hangzhou, China

391025, г.Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3-б, лит. «А»



Прошито, пронумеровано

2 листах

Директор

Кузьмина И

И. Кузьмина



ОКПД 2: 21.20.23.110

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Кранц»

Р.И. Кузьмин


«25» августа 2021 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, в вариантах исполнения
производства фирмы Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Китай

2021

1. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albascore, в вариантах исполнениях. 14 параметров (кальций, кровь, pH, креатинин, нитриты, кетоны (ацетоуксусная кислота), удельный вес, аскорбиновая кислота, глюкоза, билирубин, белок, альбумин, уробилиноген, лейкоциты), (Ca/Blo/pH/Cre/Nit/Ket/SG/Asc/Glu/Bil/Pro/Alb/Uro/Leu) U031-14C

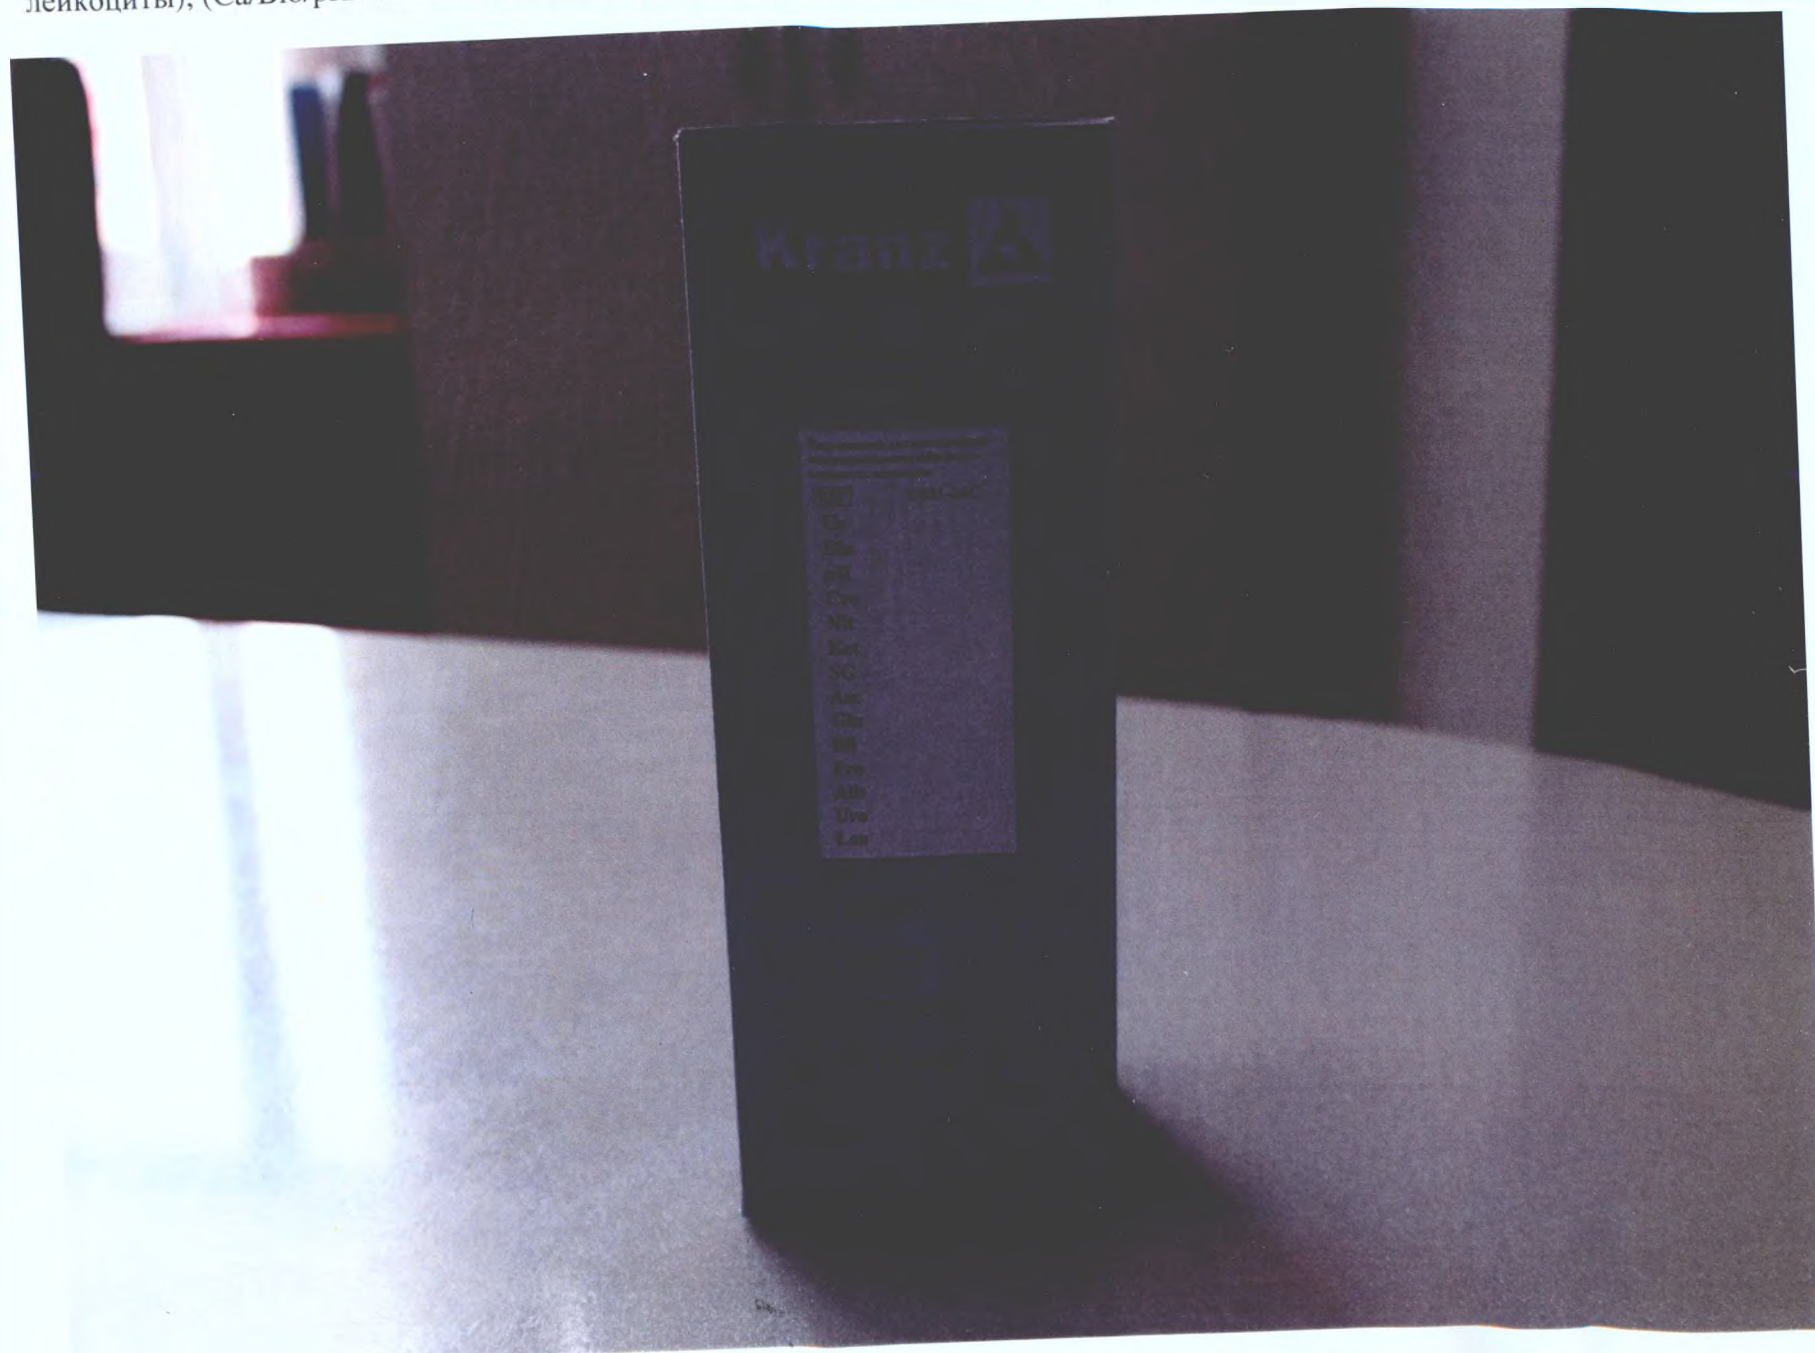



**Тест полоски для исследования
компонентов мочи Albacore
в вариантах исполнения**



LOT XXXXX

REF XXXXX



ГТТГ-ММ

ГТТГ-ММ



Уполномоченный представитель на территории РФ
ООО «Кранц»
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 Б, лит. А помещение В-Н (1)
Тел.: 8 (812) 577-37-17
E-mail: info@kranz.ru
www.kranz.ru

Производитель: Эйкон Биотех (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай
Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District,
310030 Hangzhou, China

Регистрационное удостоверение №000 0000/0000 от 00.00.0000 г.

тест-полоски для исследования компонентов мочи AtbasoG, в вариантах исполнениях: 13 параметров (кровь, pH, креатинин, нитриты, кетоны (ацетоуксусная кислота), удельный вес, аскорбиновая кислота, глюкоза, билирубин, белок, альбумин, уробилиноген, лейкоциты), (Blo/pH/Cre/Nit/Ket/SG/Asc/Glu/Bil/Pro/Alb/Uro/Leu) U034-13CE





**Тест полоски для исследования
компонентов мочи Albacore
в вариантах исполнения**

IVD



Уполномоченный представитель на территории РФ
ООО «Кранц»
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 б, лит. А помещение 8-Н (1)
Тел.: 8 (812) 577-37-17
E-mail: info@kranz.ru
www.kranz.ru

Производитель: Эйкон Биотех (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай
Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District,
310030 Hangzhou, China

Регистрационное удостоверение №000 0000/0000 от 00.00.0000 г.

LOT XXXXX

REF XXXXX



ГТТ-ММ

ГТТ-ММ




3. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, в вариантах исполнения: 11 параметров (аскорбиновая кислота, глюкоза, билирубин, кетоны (ацетоуксусная кислота), удельный вес, кровь, pH, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты), (Asc/Glu/Bil/Ket/SG/Blo/pH/Pro/Uro/Nit/Leu) U034-11A





**Тест полоски для исследования
компонентов мочи Albacore
в вариантах исполнения**




Уполномоченный представитель на территории РФ
ООО «Кранц»
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 б, лит. А помещение 8-Н (1)
Тел.: 8 (812) 577-37-17
E-mail: info@kranz.ru
www.kranz.ru

Производитель: Эйкон Биотех (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай
Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District,
310030 Hangzhou, China

Регистрационное удостоверение №000 0000/0000 от 00.00.0000 г.

LOT XXXXX
REF XXXXX




ГГГГ-ММ
ГГГГ-ММ




полоски для исследования компонентов мочи Albasore, в вариантах исполнения: 10 параметров (глюкоза, билирубин, кетоны (ацетоуксусная кислота), удельный вес, кровь, pH, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты), (Glu/Bil/Ket/SG/Blo/pH/Pro/Uro/Nit/Leu) U034-10U





**Тест полоски для исследования
компонентов мочи Albacore
в вариантах исполнения**




Уполномоченный представитель на территории РФ
ООО «Кранц»
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 Б, лит. А помещение В-Н (1)
Тел.: 8 (812) 577-37-17
E-mail: info@kranz.ru
www.kranz.ru

Производитель: Эйкон Биотех (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай
Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District.
310030 Hangzhou, China

Регистрационное удостоверение №000 000010000 от 00.00.0000 г.

LOT XXXXX
REF XXXXX



ГГГГ-ММ
ГГГГ-ММ



5. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albascore, в вариантах исполнения: 9 параметров (глюкоза, билирубин, кетоны (ацетоуксусная кислота), удельный вес, кровь, pH, белок, уробилиноген, нитриты), (Glu/Bil/Ket/SG/Blo/pH/Pro/Uro/Nit) U034-09U





**Тест полоски для исследования
компонентов мочи Albacore
в вариантах исполнения**



Уполномоченный представитель на территории РФ
ООО «Кранц»
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 б, лит. А помещение 8-Н (1)
Тел.: 8 (812) 577-37-17
E-mail: info@kranz.ru
www.kranz.ru

Производитель: Эйкон Биотех (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай
Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District,
310030 Hangzhou, China

Регистрационное удостоверение №000 0000/0000 от 00.00.0000 г.

LOT XXXXX

REF XXXXX



ГТТТ-ММ



ГТТТ-ММ



100

6. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albascore, в вариантах исполнения: 8 параметров (глюкоза, кетоны (ацетоуксусная кислота), удельный вес, кровь, pH, белок, нитриты, лейкоциты), (Glu/Ket/SG/Blo/pH/Pro/Nit/Leu) U034-08N





**Тест полоски для исследования
компонентов мочи Albacore
в вариантах исполнения**



Уполномоченный представитель на территории РФ
ООО «Кранц»
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 36, лит. А помещение 8-Н (1)
Тел.: 8 (812) 577-37-17
E-mail: info@kranz.ru
www.kranz.ru

Производитель: Эйкон Биотех (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай
Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District,
310030 Hangzhou, China

Регистрационное удостоверение №000 0000/0000 от 00.00.0000 г.

LOT XXXXX
REF XXXXX




ГГГГ-ММ
ГГГГ-ММ



9. Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albascore, в вариантах исполнения: 5 параметров (глюкоза, белок, нитриты крови, лейкоциты), (Glu/Pro/Nit/Blo/Leu) U034-05NE





**Тест полоски для исследования
компонентов мочи Albacore
в вариантах исполнения**



Уполномоченный представитель на территории РФ
ООО «Кранц»
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 б, лит. А помещение 6-Н (1)
Тел.: 8 (812) 577-37-17
E-mail: info@kranz.ru
www.kranz.ru

Производитель: Эйкон Биотех (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай
Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District,
310030 Hangzhou, China

Регистрационное удостоверение №000 0000/0000 от 00.00.0000 г.

LOT XXXXX
REF XXXXX




ПТТ-ММ
ПТТ-ММ



тест-полоски для исследования компонентов мочи Albascore, в вариантах исполнения: 4 параметра (глюкоза, удельный вес, pH, белок), (Glu/SG/pH/Pro) U034-04SE





**Тест полоски для исследования
компонентов мочи Albacore
в вариантах исполнения**



Уполномоченный представитель на территории РФ
ООО «Кранц»
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 Б, лит. А помещения 8-Н (1)
Тел.: 8 (812) 577-37-17
E-mail: info@kranz.ru
www.kranz.ru

Производитель: Эйкон Биотех (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай
Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District,
310030 Hangzhou, China

Регистрационное удостоверение №000 0000/0000 от 00.00.0000 г.

LOT XXXXX
REF XXXXX




ПТТ-ММ
ПТТ-ММ



100

тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, в вариантах исполнения 4 параметра (глюкоза, белок, нитриты, лейкоциты),
(Glu/Pro/Nit/Leu) U034-04PE





**Тест полоски для исследования
компонентов мочи Albacore
в вариантах исполнения**



LOT XXXXX
REF XXXXX



ГТТ-ММ
ГТТ-ММ



Уполномоченный представитель на территории РФ
ООО «Кранц»
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 Б, лит. А помещение 8-Н (1)
Тел.: 8 (812) 577-37-17
E-mail: info@kranz.ru
www.kranz.ru

Производитель: Эйкон Биотех (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай
Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District,
310030 Hangzhou, China

Регистрационное удостоверение №000 0000/0000 от 00.00.0000 г.

полоски для исследования компонентов мочи Albacore, в вариантах исполнения: 3 параметра (глюкоза, кетоны, белок), (Glu/Ket/Pro)
034-03KE





**Тест полоски для исследования
компонентов мочи Albacore
в вариантах исполнения**



Уполномоченный представитель на территории РФ
ООО «Кранц»
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 б, лит. А помещение 8-Н (1)
Тел.: 8 (812) 577-37-17
E-mail: info@kranz.ru
www.kranz.ru

Производитель: Эйкон Биотек (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай
Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District,
310030 Hangzhou, China

Регистрационное удостоверение №000 000010000 от 00.00.0000 г.

LOT XXXXX
REF XXXXX



ГГГГ-ММ
ГГГГ-ММ



тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, в вариантах исполнения: 3 параметра (глюкоза, рН, белок), (Glu/pH/Pro)
DO34-03PE





**Тест полоски для исследования
компонентов мочи Albacore
в вариантах исполнения**



Уполномоченный представитель на территории РФ
ООО «Кранц»
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 Б, лит. А помещение 8-Н (1)
Тел.: 8 (812) 577-37-17
E-mail: info@kranz.ru
www.kranz.ru

Производитель: Эйкон Биотех (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай
Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District,
310030 Hangzhou, China

Регистрационное удостоверение №0000 0000/0000 от 00.00.0000 г.

LOT XXXXX
REF XXXXX




ГГГГ-ММ
ГГГГ-ММ




наборы для исследования компонентов мочи Albacore, в вариантах исполнения: 2 параметра (глюкоза, белок), (Glu/Pro) U034- 02GE





**Тест полоски для исследования
компонентов мочи Albacore
в вариантах исполнения**




Уполномоченный представитель на территории РФ
ООО «Кранц»
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 б, лит. А помещение 8-Н (1)
Тел.: 8 (812) 577-37-17
E-mail: info@kranz.ru
www.kranz.ru

Производитель: Эйкон Биотех (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай
Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District,
310030 Hangzhou, China

Регистрационное удостоверение №000 0000/0000 от 00.00.0000 г.

LOT XXXXX
REF XXXXX



...оски для исследования компонентов мочи Albacore, в вариантах исполнения: 2 параметра (альбумин, креатинин), (Alb/Cre)





**Тест полоски для исследования
компонентов мочи Albascore
в вариантах исполнения**



Уполномоченный представитель на территории РФ
ООО «Кранц»
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 б, лит. А помещение 8-Н (1)
Тел.: 8 (812) 577-37-17
E-mail: info@kranz.ru
www.kranz.ru

Производитель: Эйкон Биотех (Ханжоу) Ко., Лтд., Китай
Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District,
310030 Hangzhou, China

Регистрационное удостоверение №000 0000/0000 от 00.00.0000 г.

LOT XXXXX

REF XXXXX



ГТТГ-ММ



ГТТГ-ММ



Прошито, пронумеровано на

32 листах

Директор Кузьмин Р.И.



ОКПД 2: 21.20.23.110

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Кранц»

Р.И. Кузьмин

«25» августа 2021



МАКЕТ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, в вариантах исполнения
производства фирмы Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Китай

2021



**Тест-полоски для исследования
компонентов мочи Albascore
в вариантах исполнения**





Размер
28x60мм

REF XXXXX

LOT XXXXX

MTT-MM


MTT-MM

100

Уполномоченный представитель на территории РФ
ООО «Кранц»
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 б, лит. А
помещение 8-Н (1)
Тел.: 8 (812) 577-37-17
E-mail: info@kranz.ru
www.kranz.ru

Производитель: Эйкон Биотех (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай
Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District,
310030 Hangzhou, China

Регистрационное удостоверение №000 0000/0000 от 00.00.0000 г.

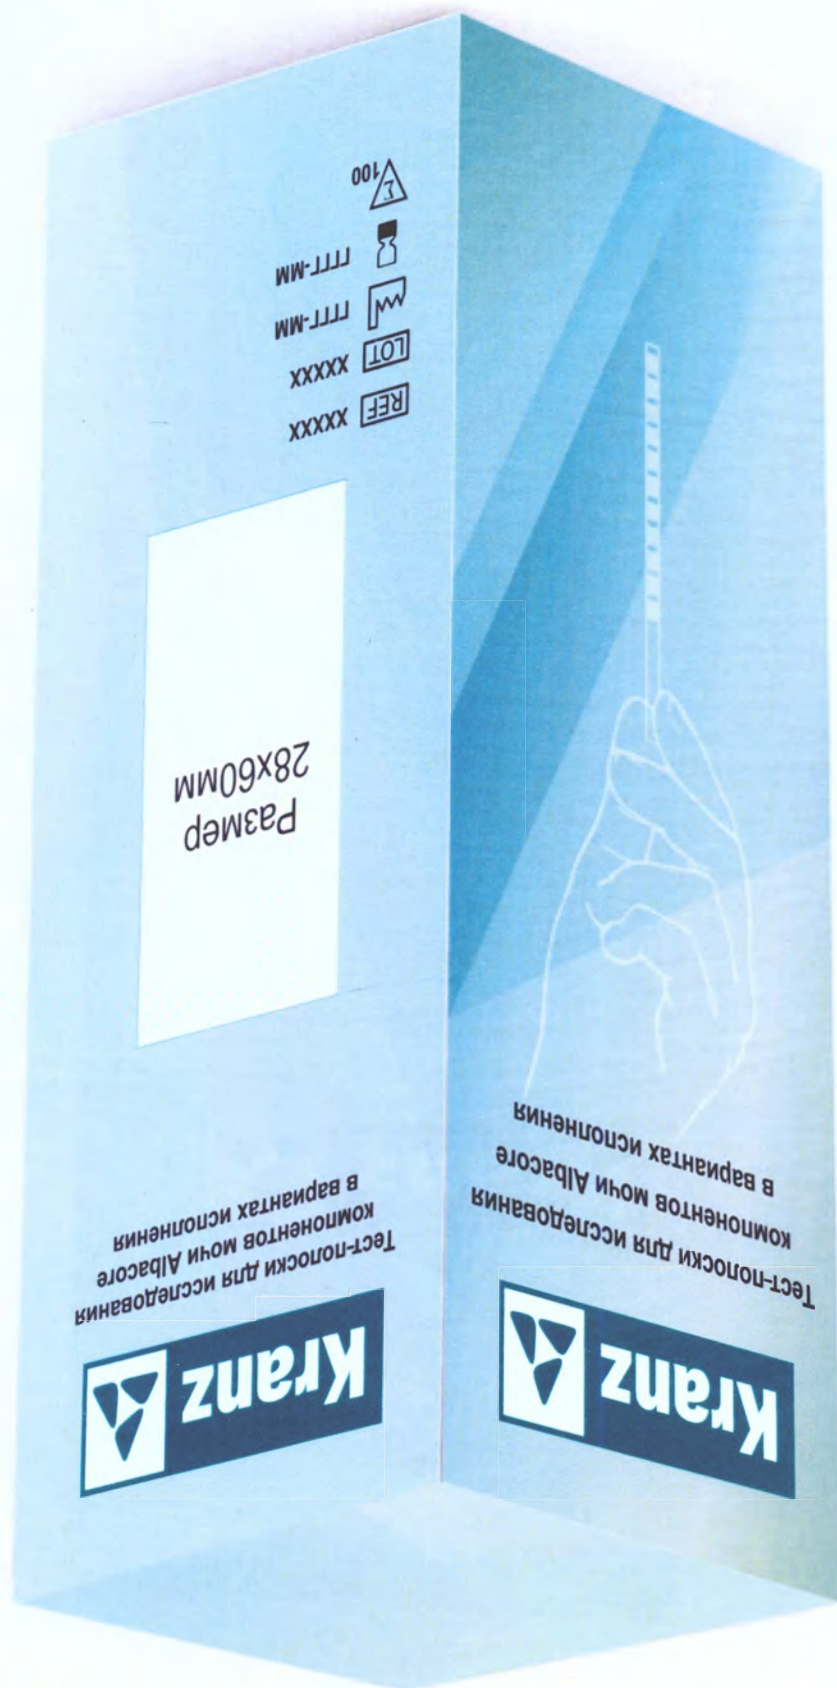

Kranz 

- Тест-полоски - 100 шт
- Инструкция по применению



Kranz 

Kranz 

- Тест-полоски - 100 шт
- Инструкция по применению

Kranz 

Тест-полоски для исследования
компонентов мочи Albacore
в вариантах исполнения

Kranz 

Тест-полоски для исследования
компонентов мочи Albacore
в вариантах исполнения

Размер
28x60мм

Уполномоченный представитель на территории РФ
ООО «Кранц»
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маковского 3 Б, лит. А,
помещение 8-Н (1)
Тел.: 8 (812) 577-37-17
E-mail: info@kranz.ru
www.kranz.ru

Производитель: Эйкон Биотек (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай
Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District,
310030 Hangzhou, China

Регистрационное удостоверение №000 0000/0000 от 00.00.0000 г.



REF XXXXX

LOT XXXXX

ГТТГ-ММ

ГТТГ-ММ

100

51,00 мм

130,00 мм

51,00 мм



Тест полоски для исследования
компонентов мочи Albacore
в вариантах исполнения

Тест полоски для исследования
компонентов мочи Albacore U500
в вариантах исполнения

IVD

Вес брутто 25 кг
Вес нетто 24 кг

Регистрационное удостоверение
№ 000 000010000

Уполномоченный представитель, производимый в России:
Общество с ограниченной ответственностью «Кранх» ООО «Кранх»,
191025, город Санкт-Петербург, улица Малоговского, дом 36 литер А, помещение № 6-11 (1)

 Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
Эйкон Биотек (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай



Прошито, пронуме
6 листах
Директор Кузьми



ОКПД 2: 21.20.23.110

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Кран»

Р.И. Кузьмин

«25» августа 2021



МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Тест-полоски для исследования компонентов мочи Albacore, в вариантах исполнения
производства фирмы Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Китай

2021

98,00 mm

28,00 mm

Kranz



**Тест-полоски для исследования
компонентов мочи Albacore
в вариантах исполнения**

IVD



Уполномоченный представитель на территории РФ
ООО «Кранц»
191025, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского 3 б, лит. А помещение 8-Н (1)
Тел.: 8 (812) 577-37-17
E-mail: info@kranz.ru
www.kranz.ru

Производитель: Эйкон Биотех (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай
Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District,
310030 Hangzhou, China

Регистрационное удостоверение №000 0000/0000 от 00.00.0000 г.

LOT XXXXX

REF XXXXX



ГТГГ-ММ



ГТГГ-ММ



92,00 MM

98,00 MM

LEU 120 s						Leu/μL
URO 60 s						mg/dL(μmol/L)
ALB 60 s						mg/dL (mg/L)
PRO 60 s						mg/dL(g/L)
BIL 60 s						mg/dL(μmol/L)
GLU 60 s						mg/dL(mmol/L)
ASC 60 s						mg/dL(mmol/L)
SG 60 s						1.025 1.030
KET 60 s						mg/dL(mmol/L)
NIT 60 s						mg/dL(mmol/L)
CRE 60 s						mg/dL(mmol/L)
pH 60 s						8.0 9.0
BLO 60 s						5-10 50 Ery/μL
CA 60 s						mg/dL(mmol/L)

1170255802

