

ОКПД 2: 26.60.12.119

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Кранц»

И.В. Кузьмина

«10» апреля 2019 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Анализатор мочи Albacore U500, с принадлежностями
производства фирмы Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Китай

2019


1. Бумага для термопринтера, 2 рулона



2. Термопринтер

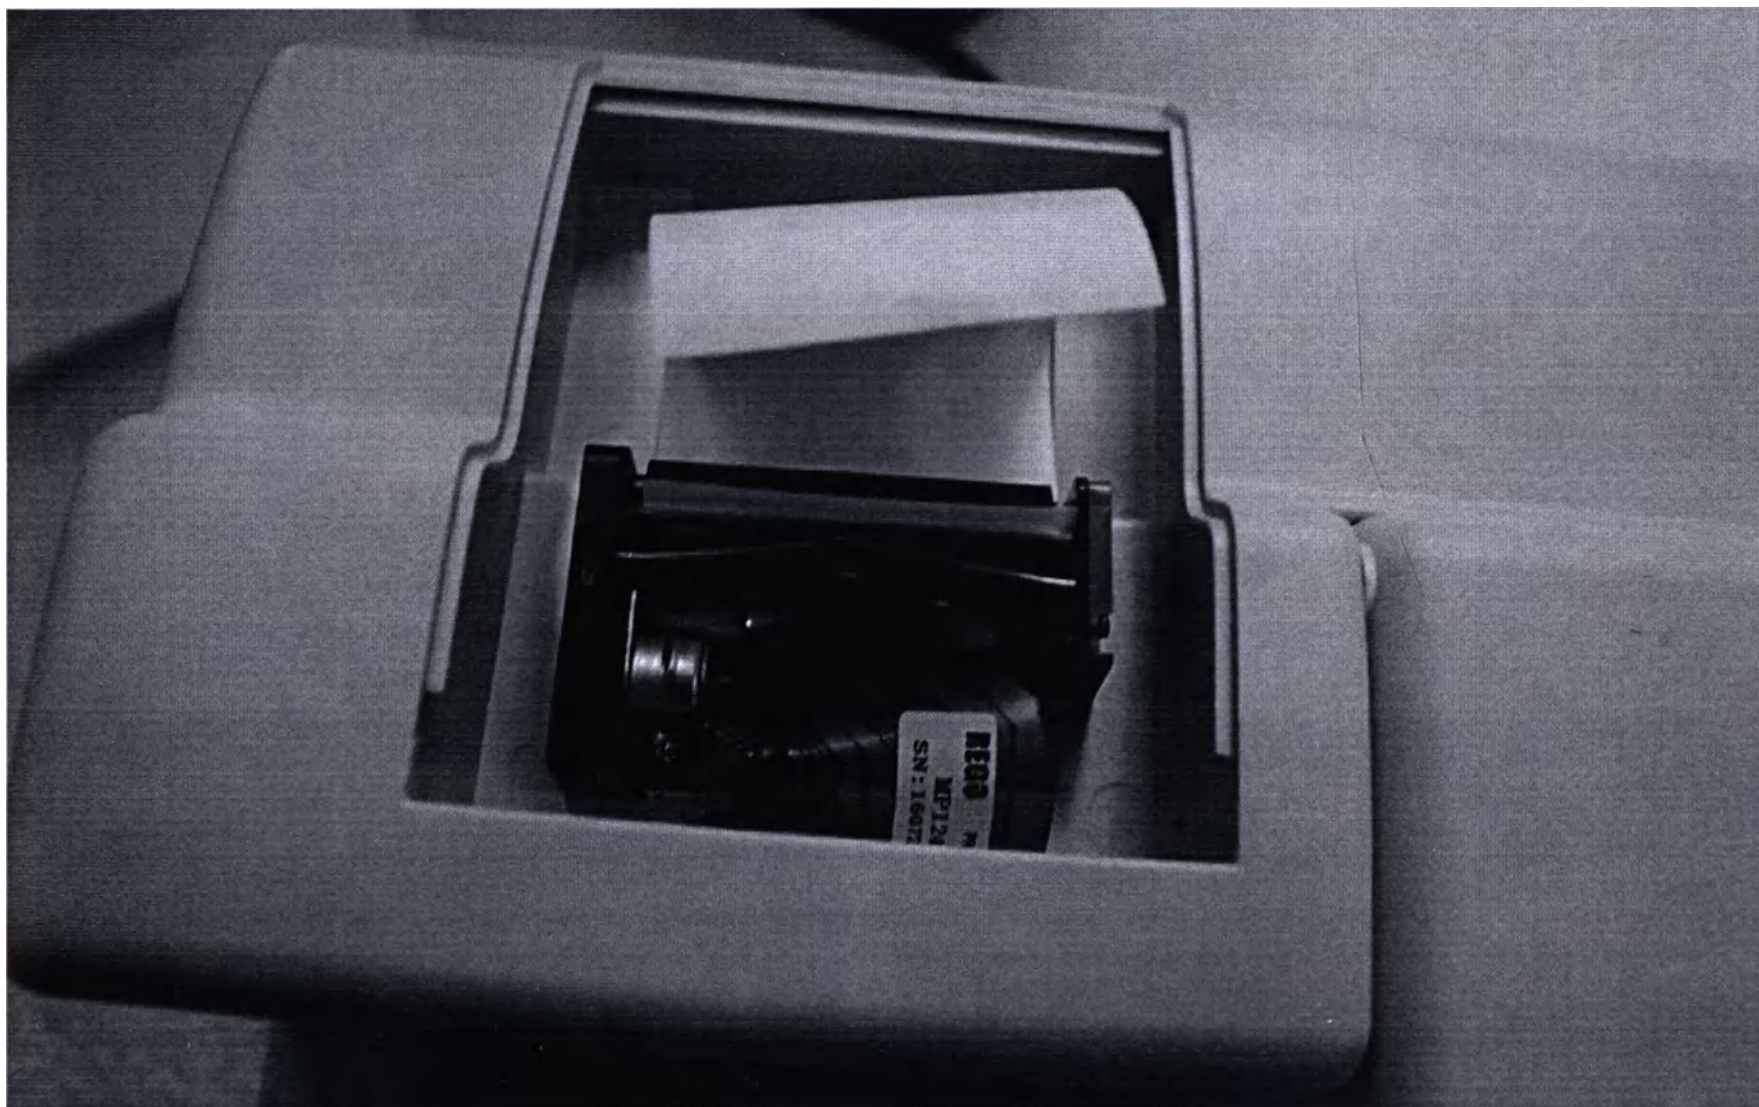

3. Кабель интерфейсный последовательный RS-232

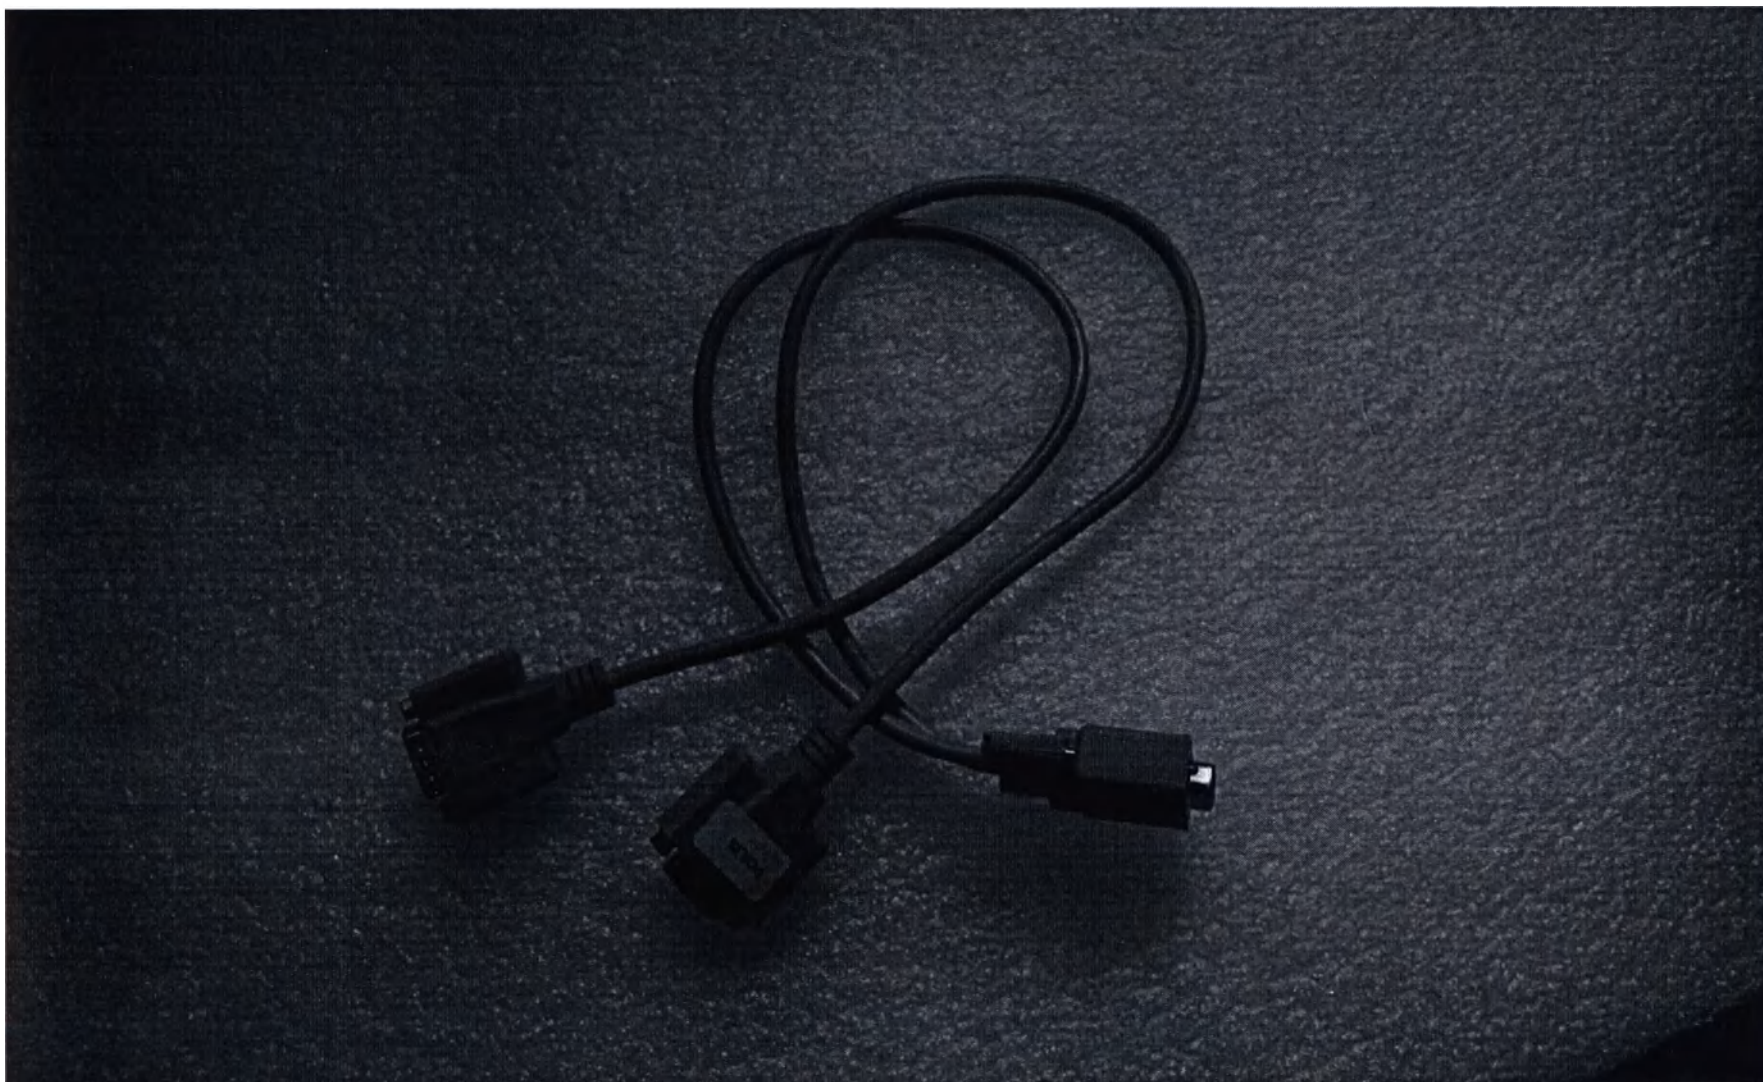

4. Полоски калибровочные для контроля качества (норма/патология, 2 шт./1 туба)




5. Считыватель штрих-кода


6. Кабель для сканера штрих-кодов



7. Предохранители 2.0 А, не более 2 шт.

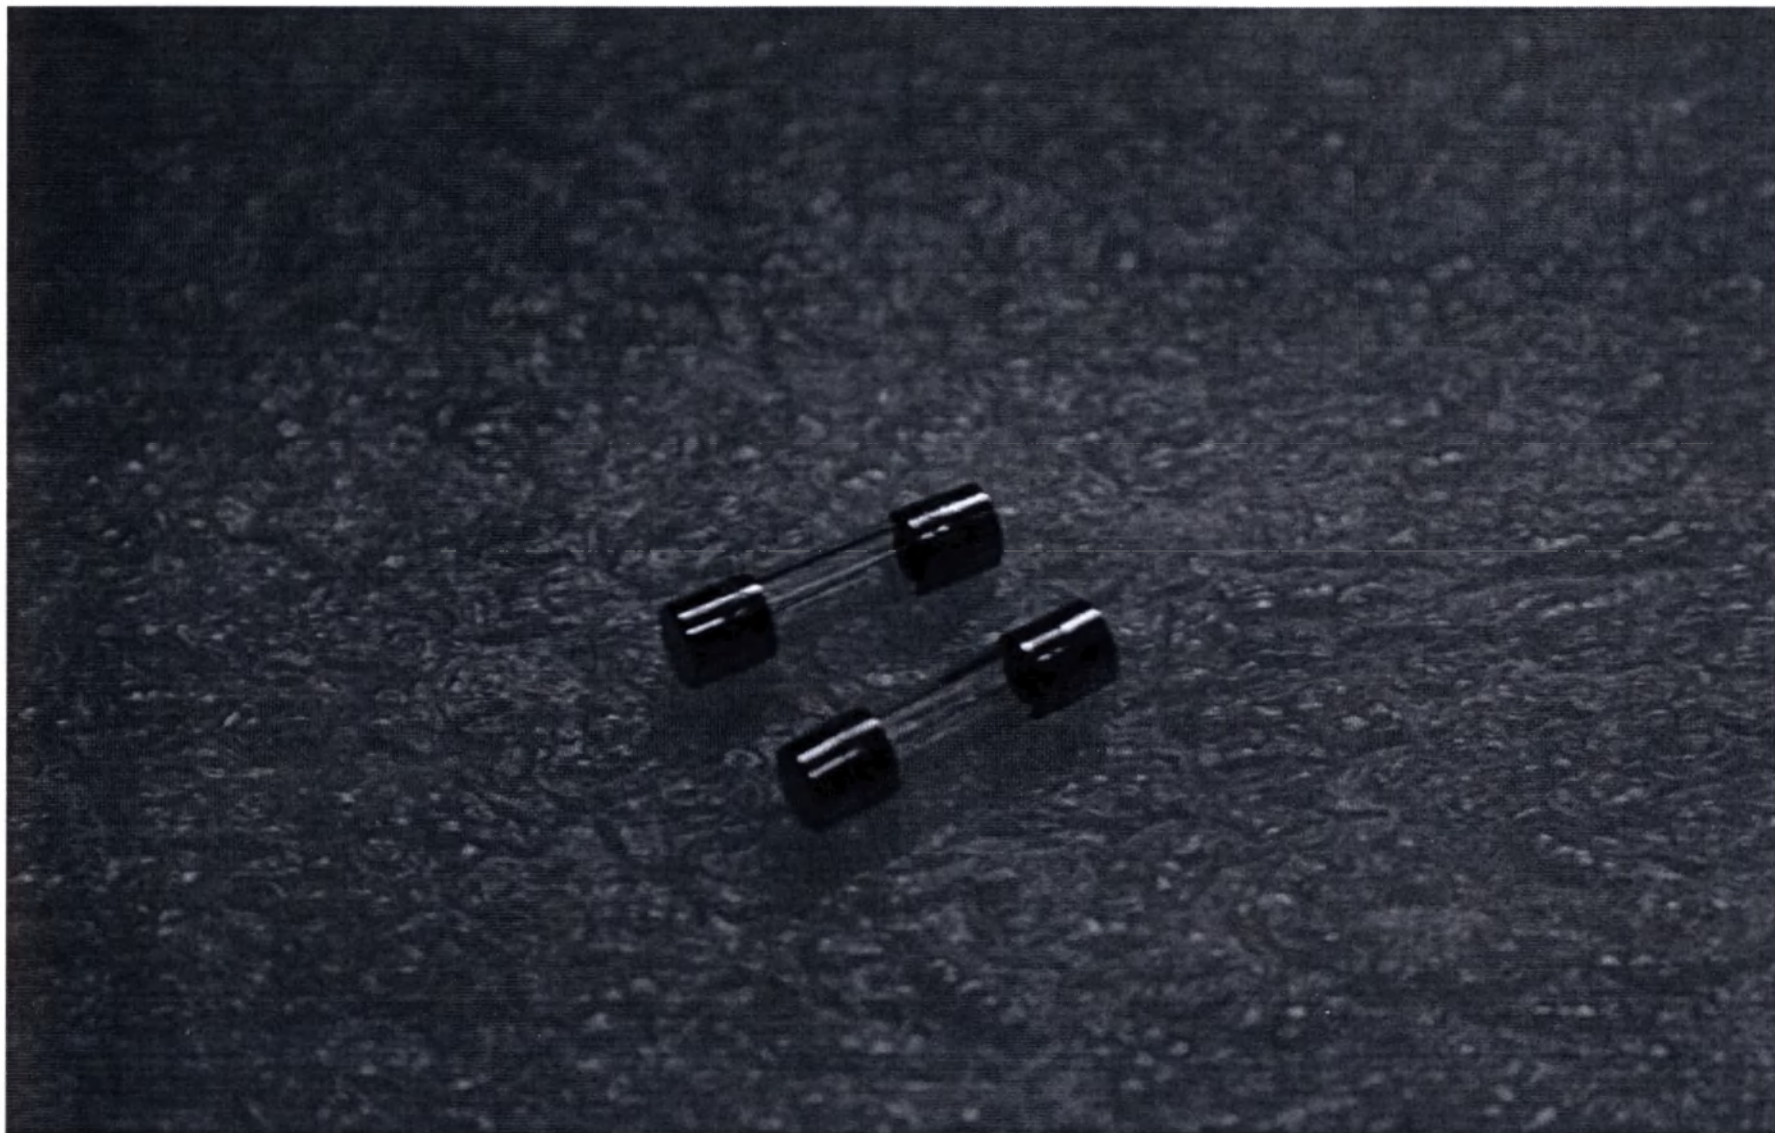


8. Лоток для отходов

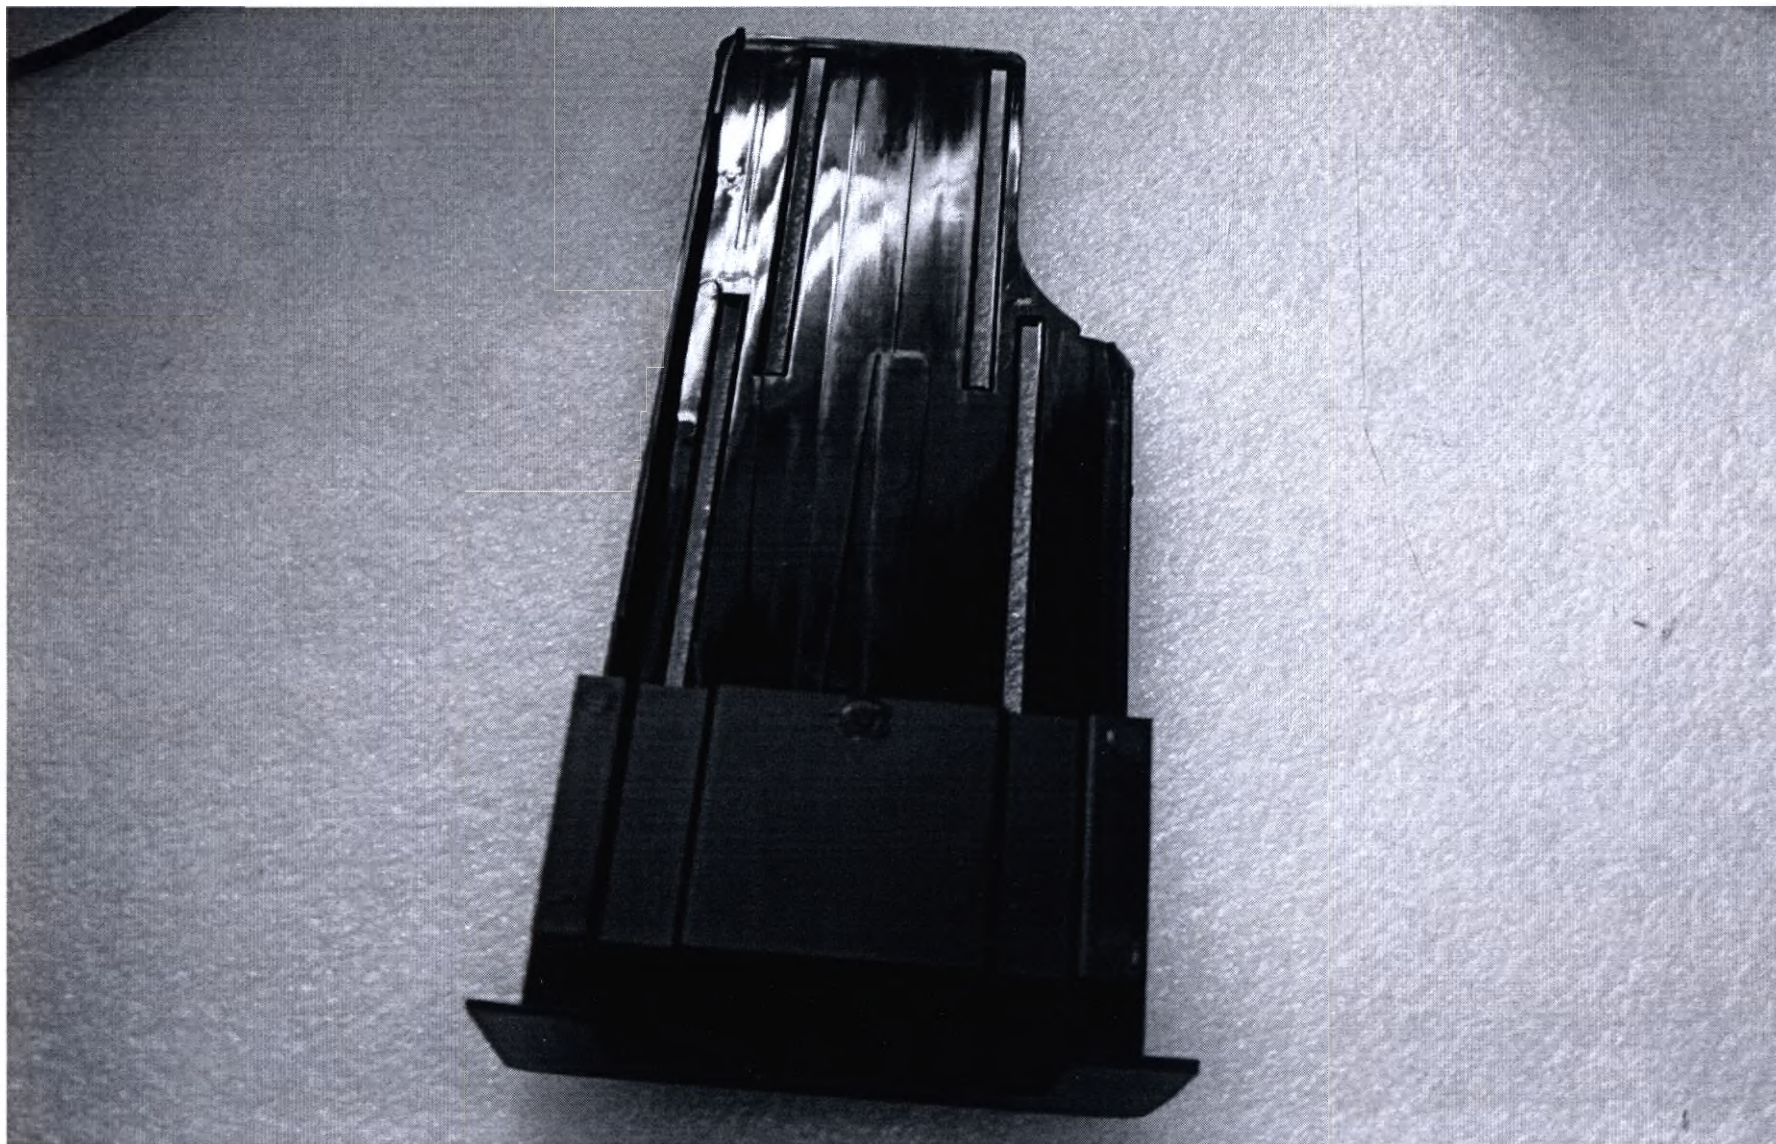





9. Платформа для подачи полосок

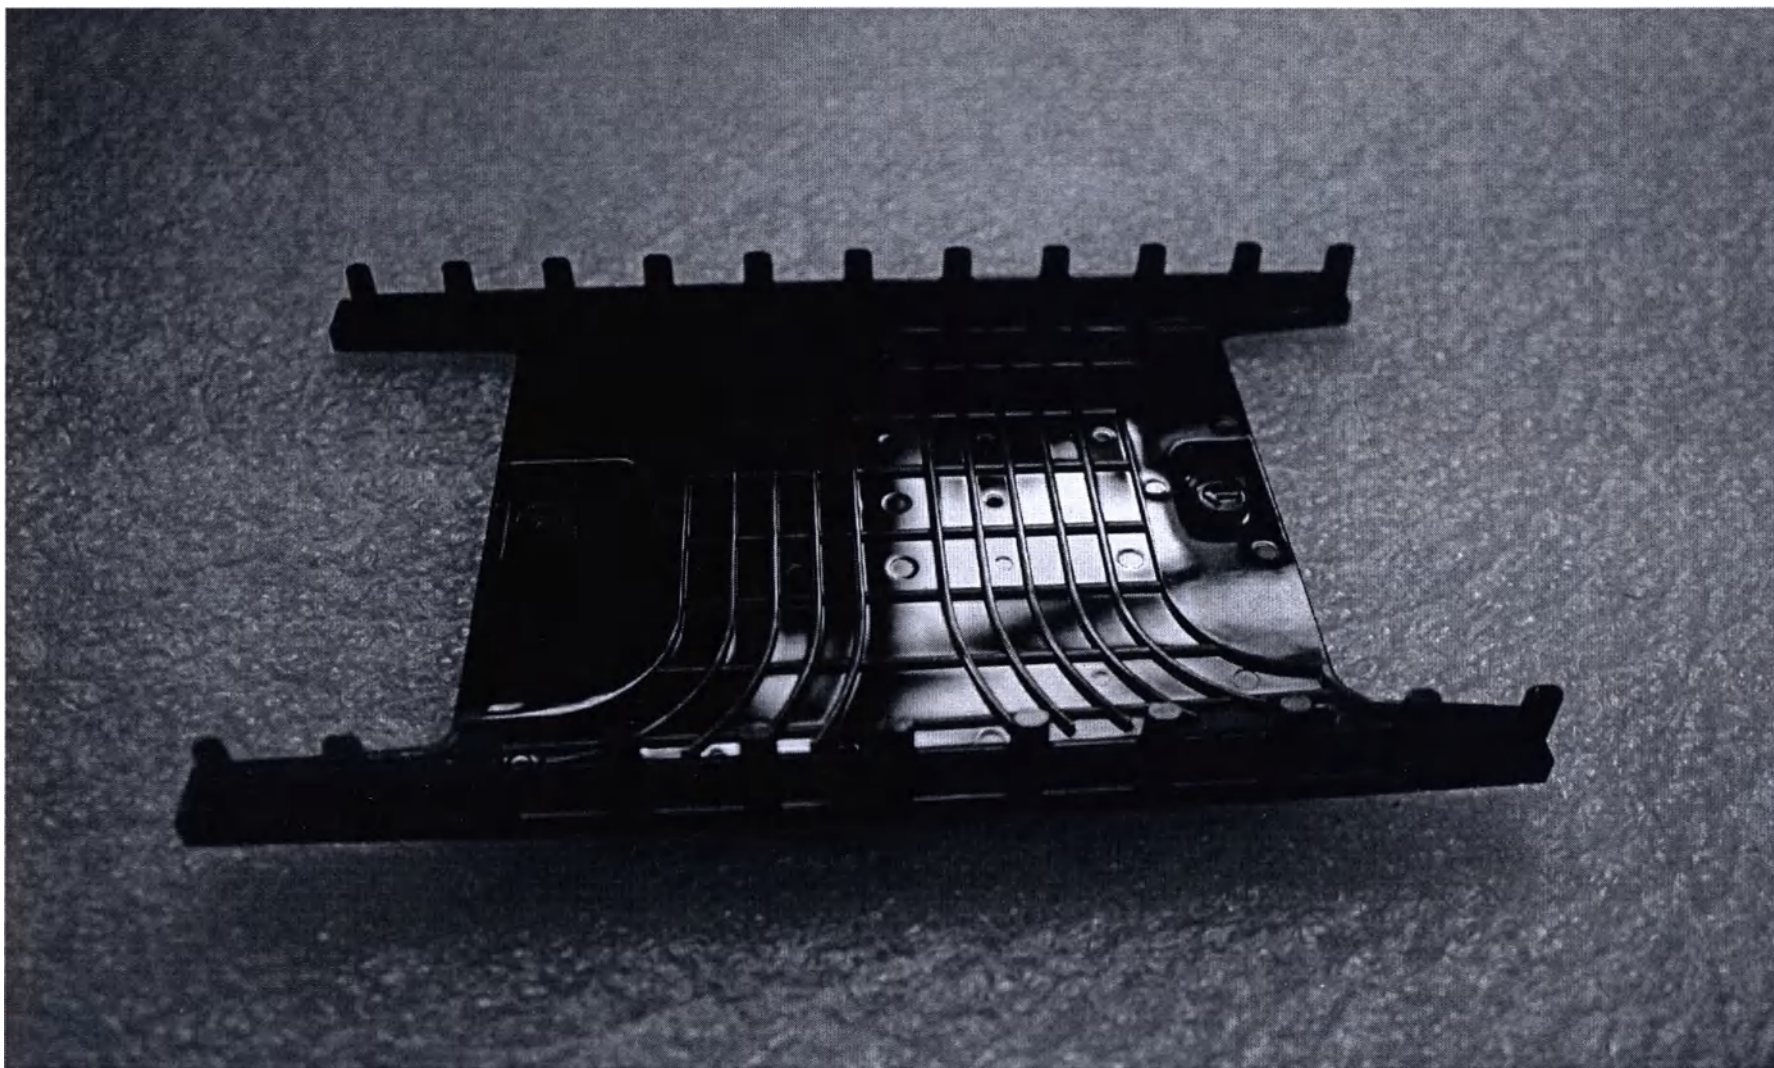

10. Руководство по эксплуатации

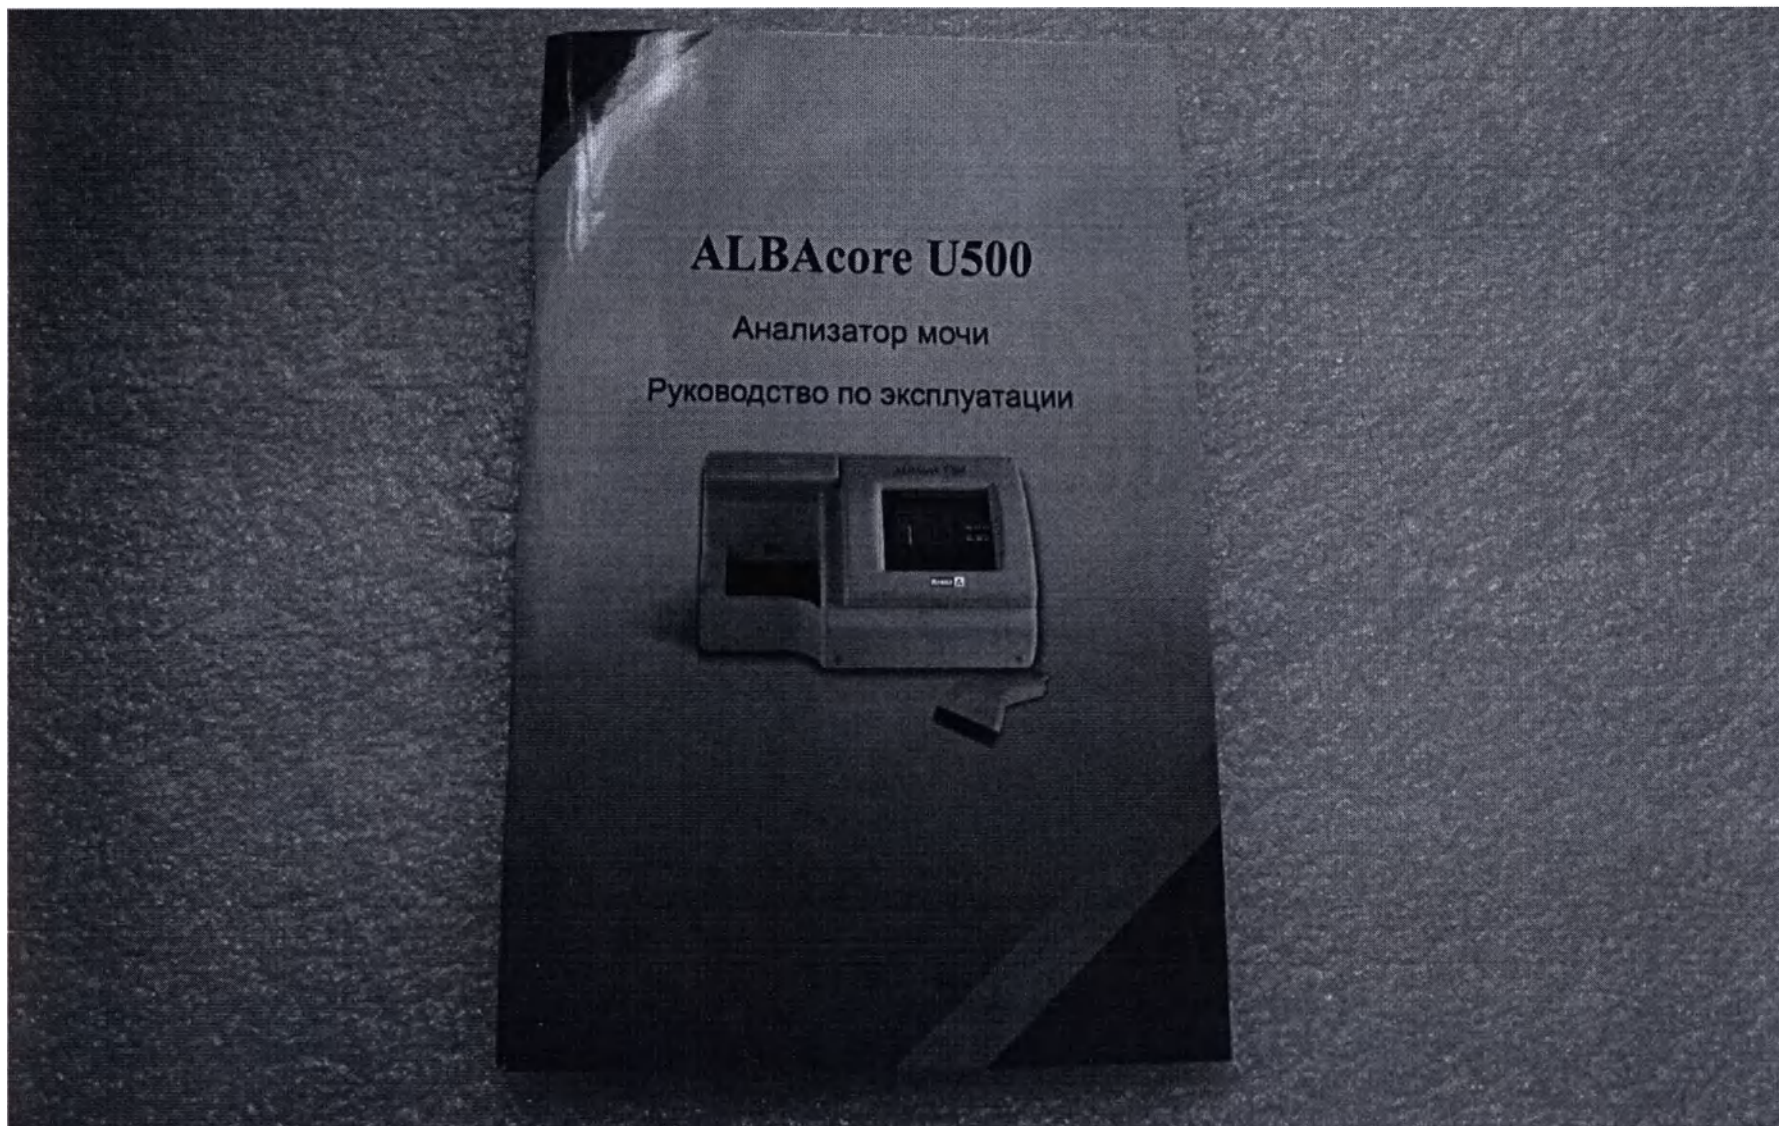

11. Технический паспорт

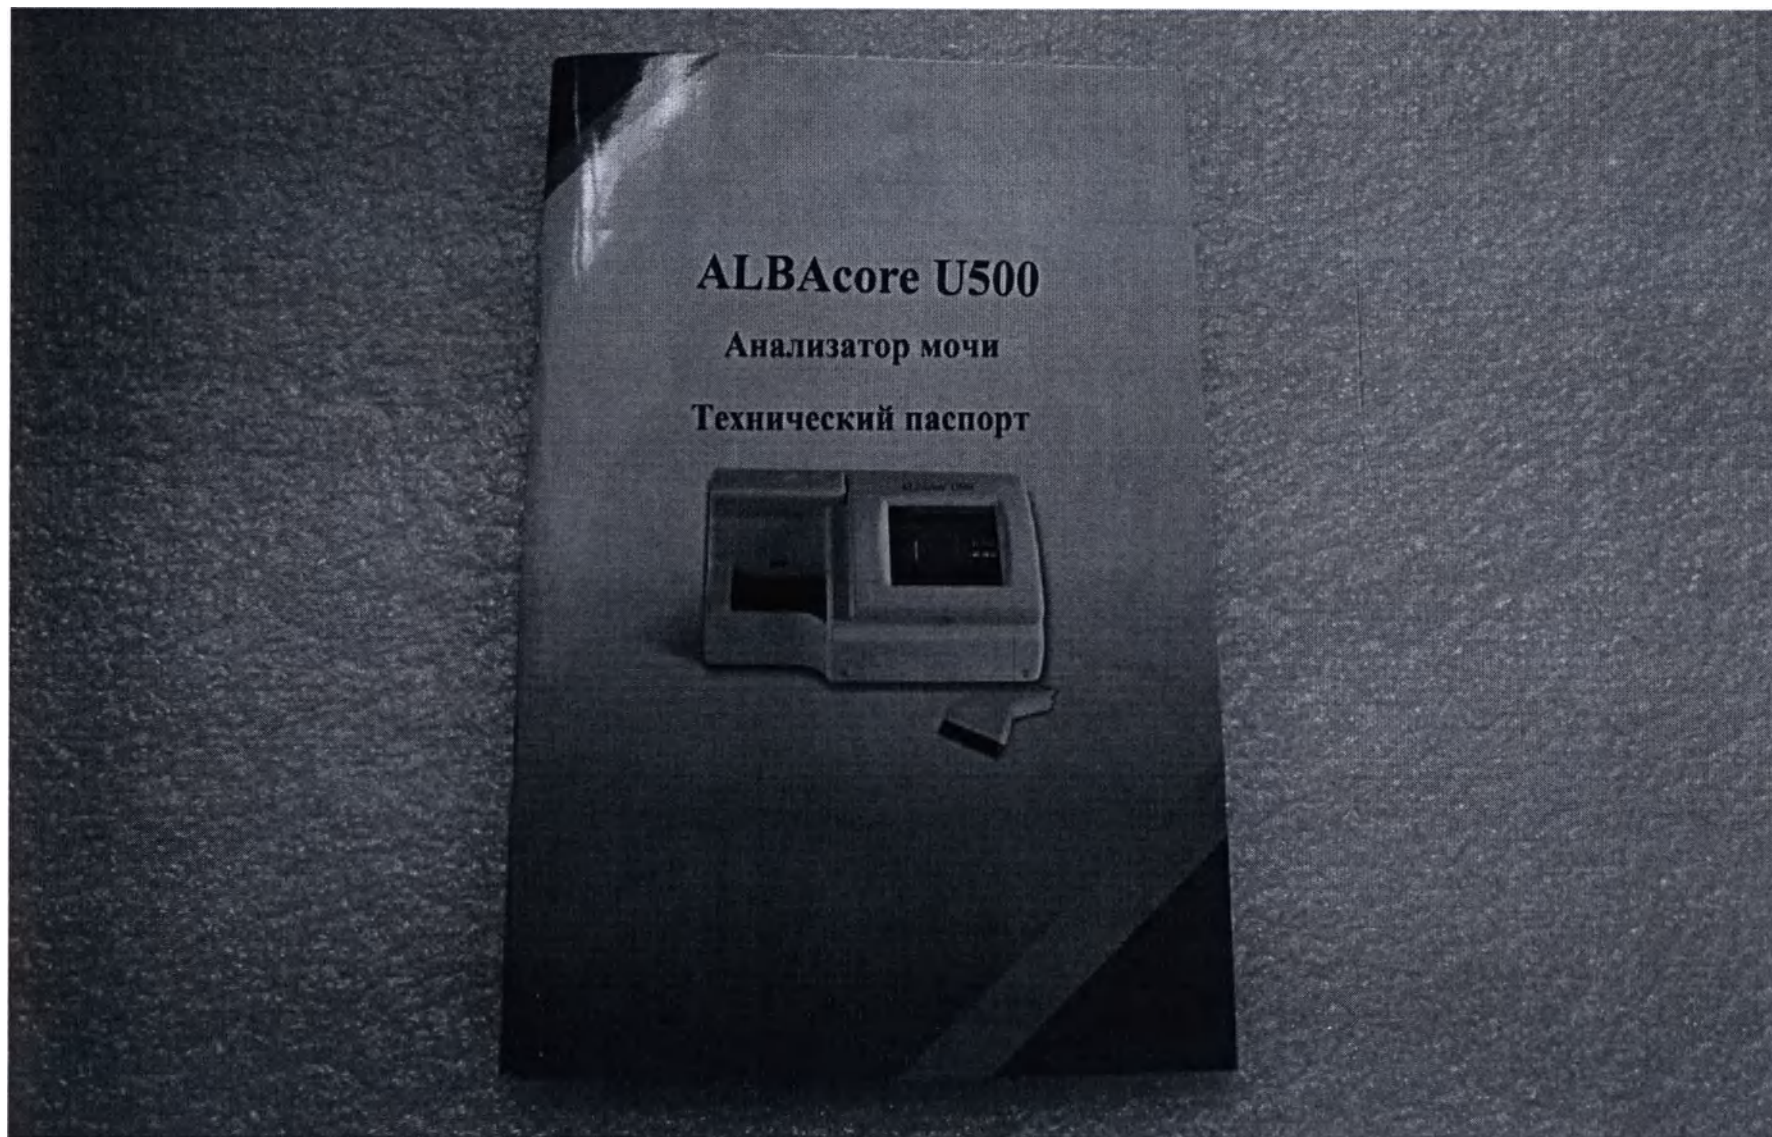

12. Кабель питания




13. Стартовый набор тест-полосок для исследования мочи 200 шт. 2 тубы (100 шт/туба)

Kranz 

■ Тест полоски, 100 шт

Kranz 

Тест полоски для исследования компонентов мочи Albacore

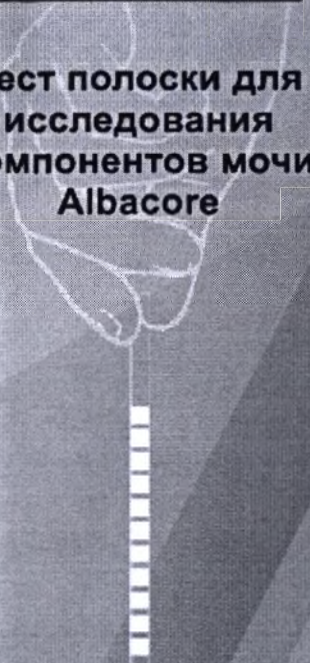

14 параметров (Аскорбиновая кислота, Глюкоза, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Удельный вес, Кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты, Альбумин, Креатинин, Кальций)

Kranz 

Тест полоски для исследования компонентов мочи Albacore

14 параметров (Аскорбиновая кислота, Глюкоза, Билирубин, Кетоны (ацетоуксусная кислота), Удельный вес, Кровь, pH, Белок, Уробилиноген, Нитриты, Лейкоциты, Альбумин, Креатинин, Кальций)

ASC
GLU
BIL
KET
SG
BLO
pH
PRO
URO
NIT
LEU
ALB
CRE
Ca

REF U031-141C

LOT URS6060201

03.2019

ООО «Кранц»
191026, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского
3-б, лит. «А»

Производитель:
ACON Biotech (Hangzhou) Co., Ltd., Китай
No. 210 Zhenzhong Road, West Lake District,
310030 Hangzhou, China

Kranz 


Регистрационное удостоверение
№000 0000/0000

IVD  

IVD

IVD

IVD

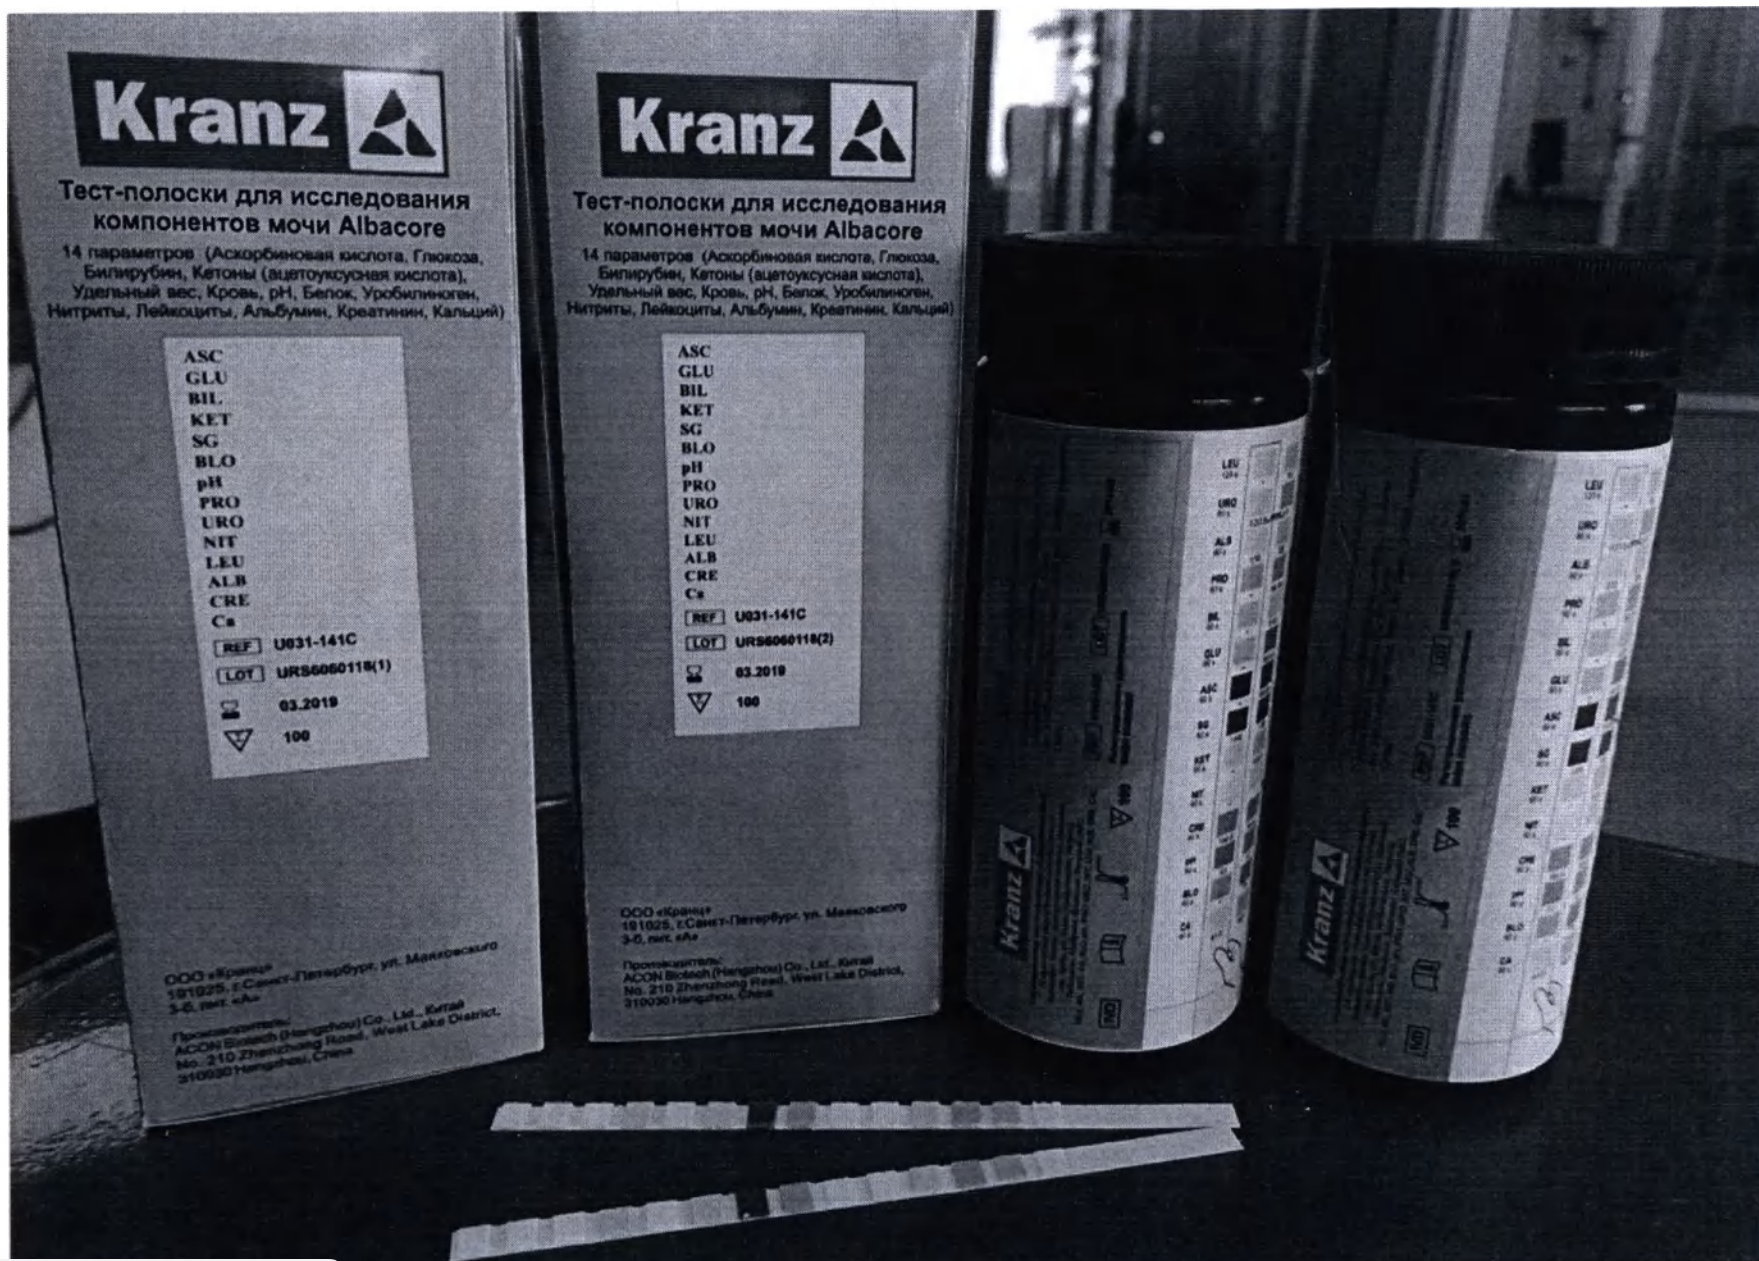

14. Пылезащитный чехол для мочевого анализатора



15. Набор контрольной мочи для контроля качества №1: 1 уровень (норма) (1 флакон 10 мл),
2 уровень (патология) (1 флакон 10 мл)
16. Набор контрольной мочи для контроля качества №2: 1 уровень (норма) (1 флакон 5 мл),
2 уровень (патология) (1 флакон 5 мл)



Анализатор мочи Albacore U500, с принадлежностями



В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
18 (восемнадцати) листа(ов)

Директор
ООО «Кранц»

И.В. Кузьмина Кузьмина И.В.
18.09.2019 2019 г.



ОКПД 2: 26.60.12.119

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Кранц»

И.В. Кузьмина

«10» апреля 2019 г.



**МАКЕТ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Анализатор мочи Albacore U500, с принадлежностями
производства фирмы Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Китай**

2019



Анализатор мочи Albacore U500

SN

IVD

Вес брутто 7,2 кг

Вес нетто 6,8 кг

Регистрационное удостоверение
№ 000 0000/0000

ООО "Кранц"

РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 3-б, литер А, 191025



Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.

Эйкон Биотех (Ханчжоу) Ко., Лтд., Китай



В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) листа(ов)

Директор
ООО «Кранц»

Кузьмина И.В.
10.09.2019 2019 г.



ОКПД 2: 26.60.12.119

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Кранц»

И.В. Кузьмина

«10» апреля 2019 г.





МАКЕТ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Анализатор мочи Albacore U500, с принадлежностями

производства фирмы Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. Китай

2019

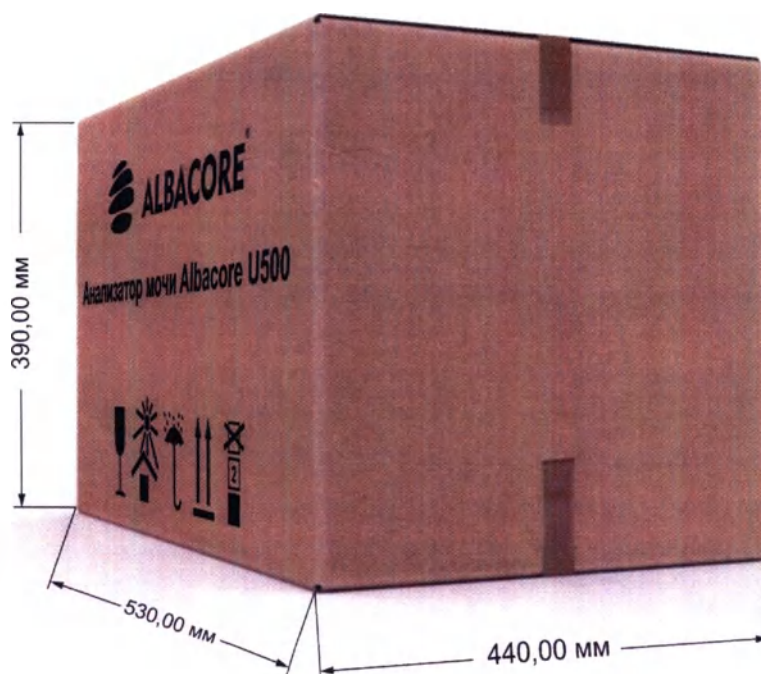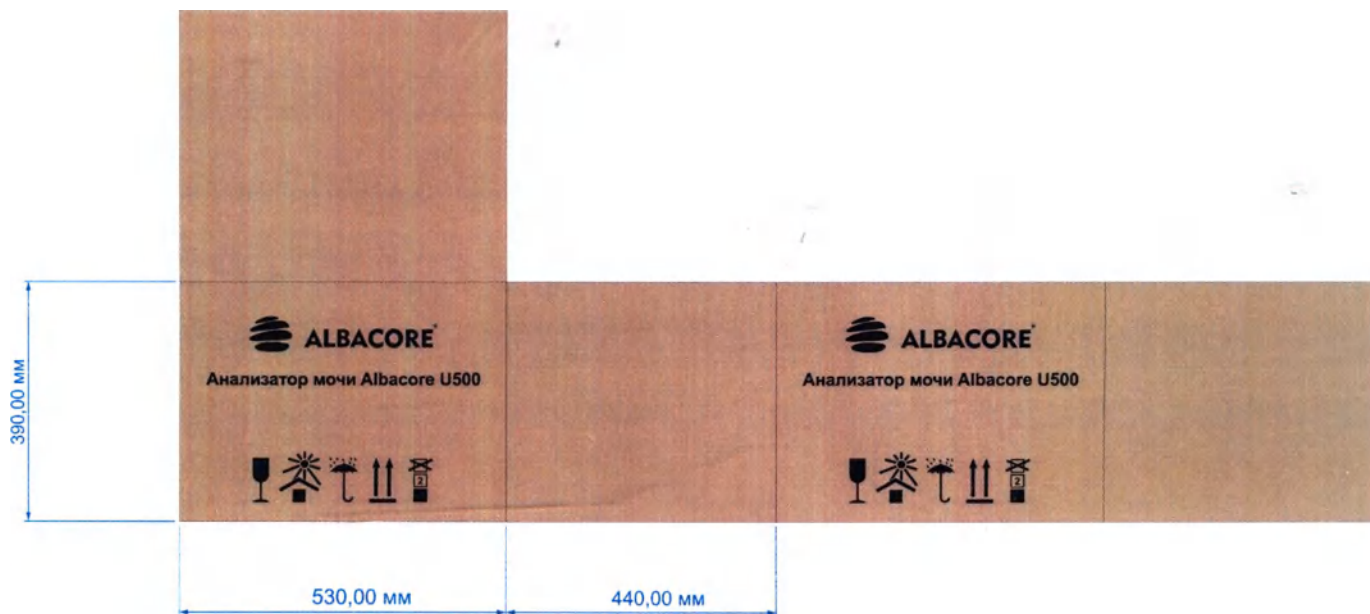

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
2 10/2019 листа(ов)

Директор

ООО «Кранц»

Кузьмина И.В.
10/2019 2019 г.

