



Альбом с фотографическими изображениями медицинского изделия
«Прибор диагностический ультразвуковой медицинский «Комплексмед»
по ТУ 9442-002-31722767-2010
в следующих исполнениях: 1.1; 1.2; 1.3; 3.3; 4.3»

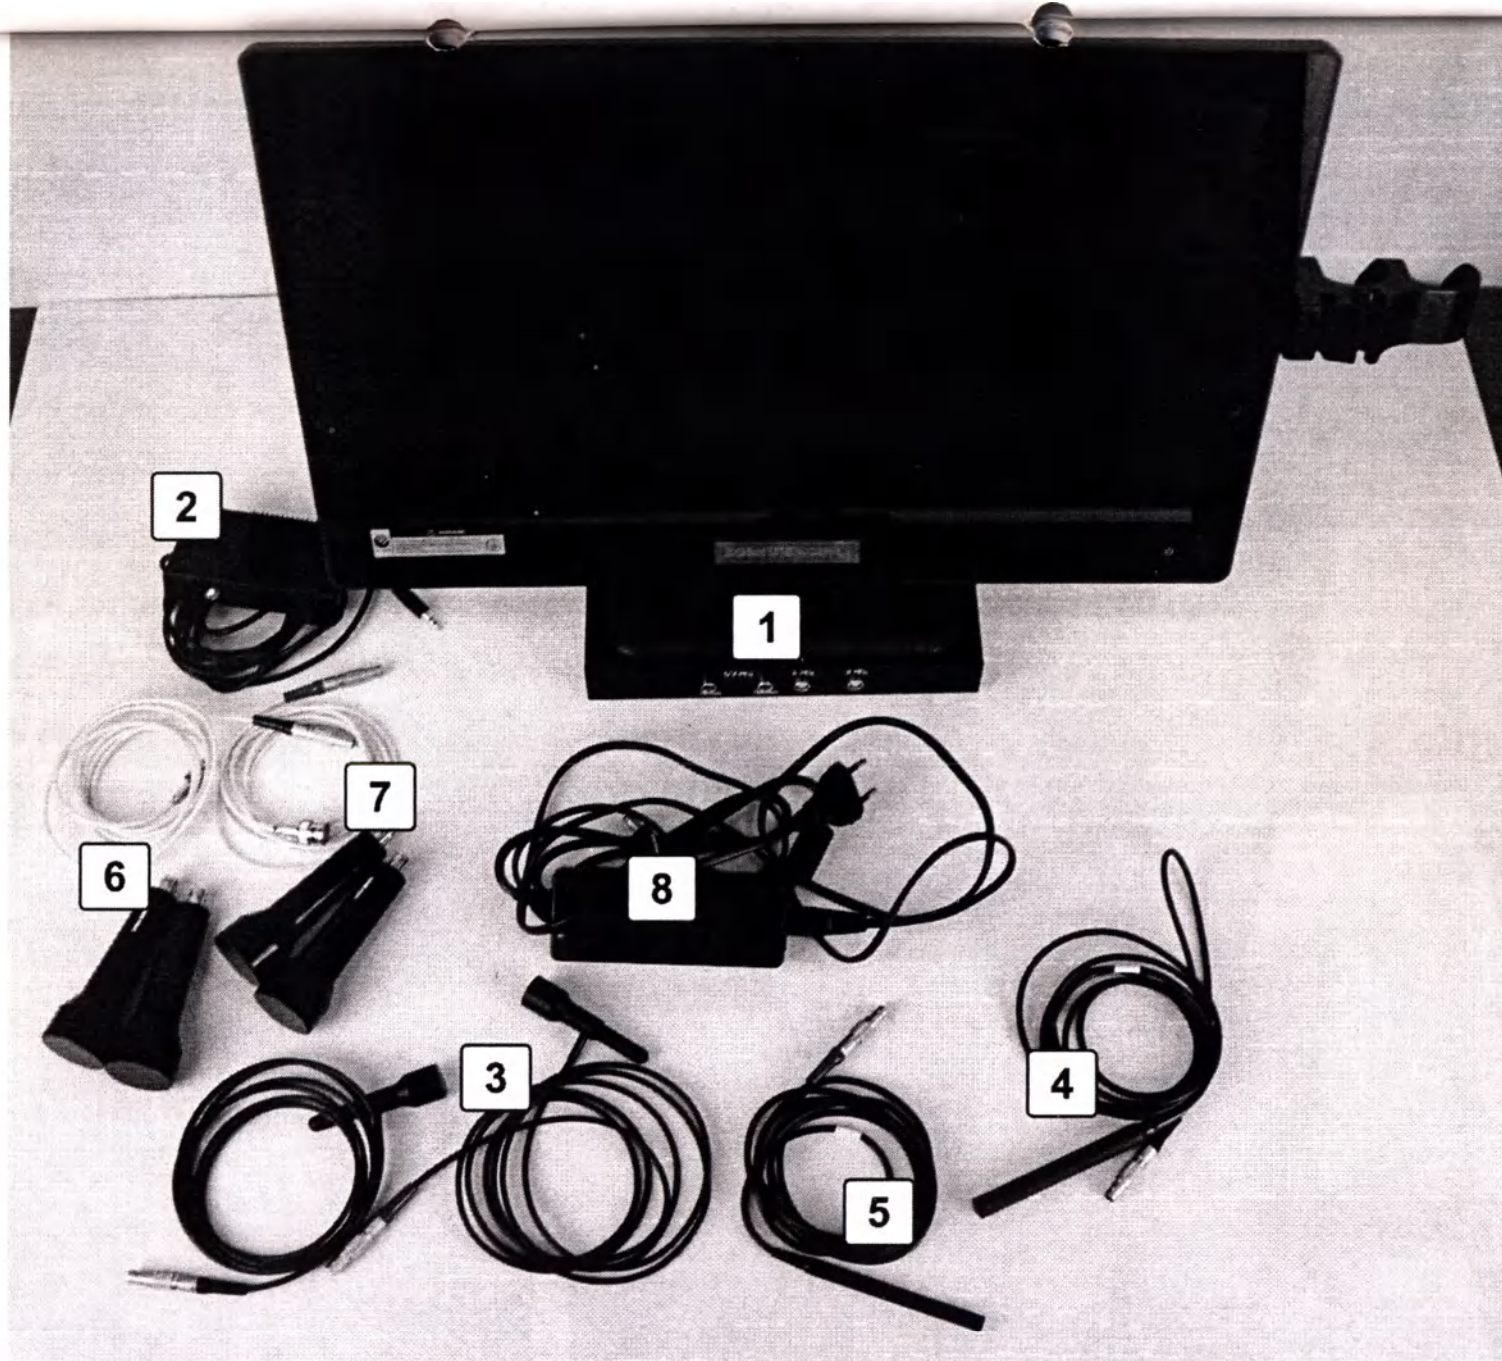


Прибор диагностический ультразвуковой медицинский Комплексмед, исполнение 1.1 общий вид

Обозначения на фотографическом изображении медицинского изделия «Прибор диагностический ультразвуковой
медицинский Комплексмед, исполнение 1.1»

1. Моноблок со встроенным анализатором доплеровский скорости кровотока с функцией двухканального эхоэнцефалографа.
2. Педаль ножная.
3. Ультразвуковой датчик для режима импульсного доплера 2 МГц PW.
4. Ультразвуковой датчик для режима непрерывного доплера 4 МГц CW.
5. Ультразвуковой датчик для режима непрерывного доплера 8 МГц CW.
6. Ультразвуковой датчик с соединительным кабелем для режима эхоэнцефалографа 1 МГц.
7. Ультразвуковой датчик с соединительным кабелем для режима эхоэнцефалографа 2 МГц.
8. Медицинский сетевой адаптер.

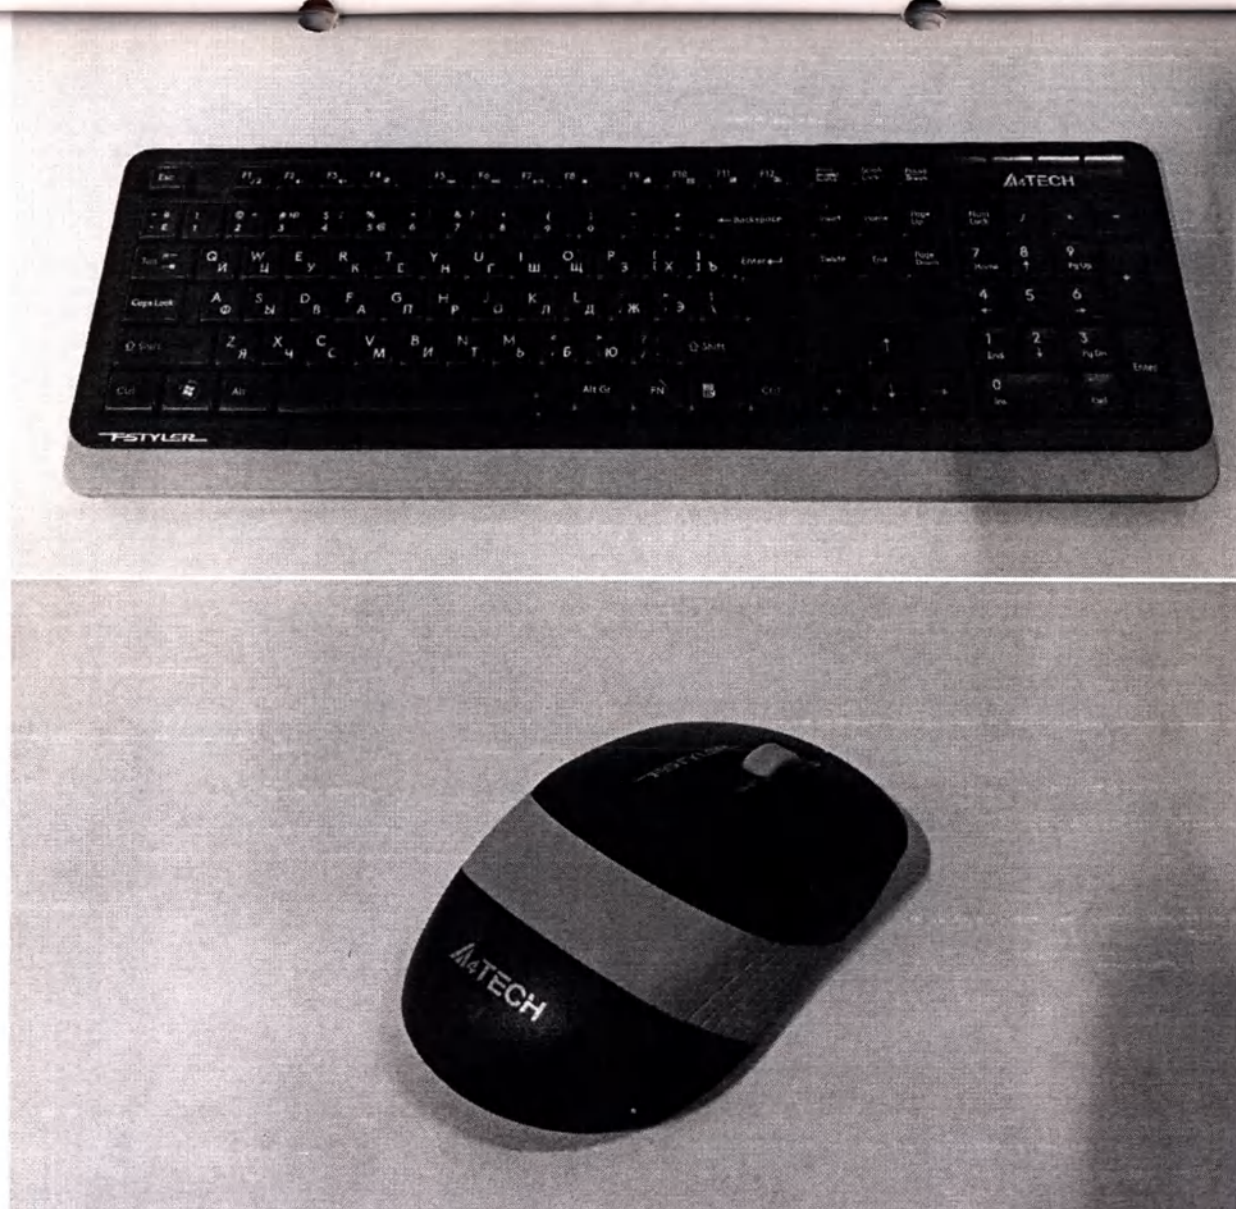


Прибор диагностический ультразвуковой медицинский Комплексмед, исполнение 1.1: Клавиатура и мышь.

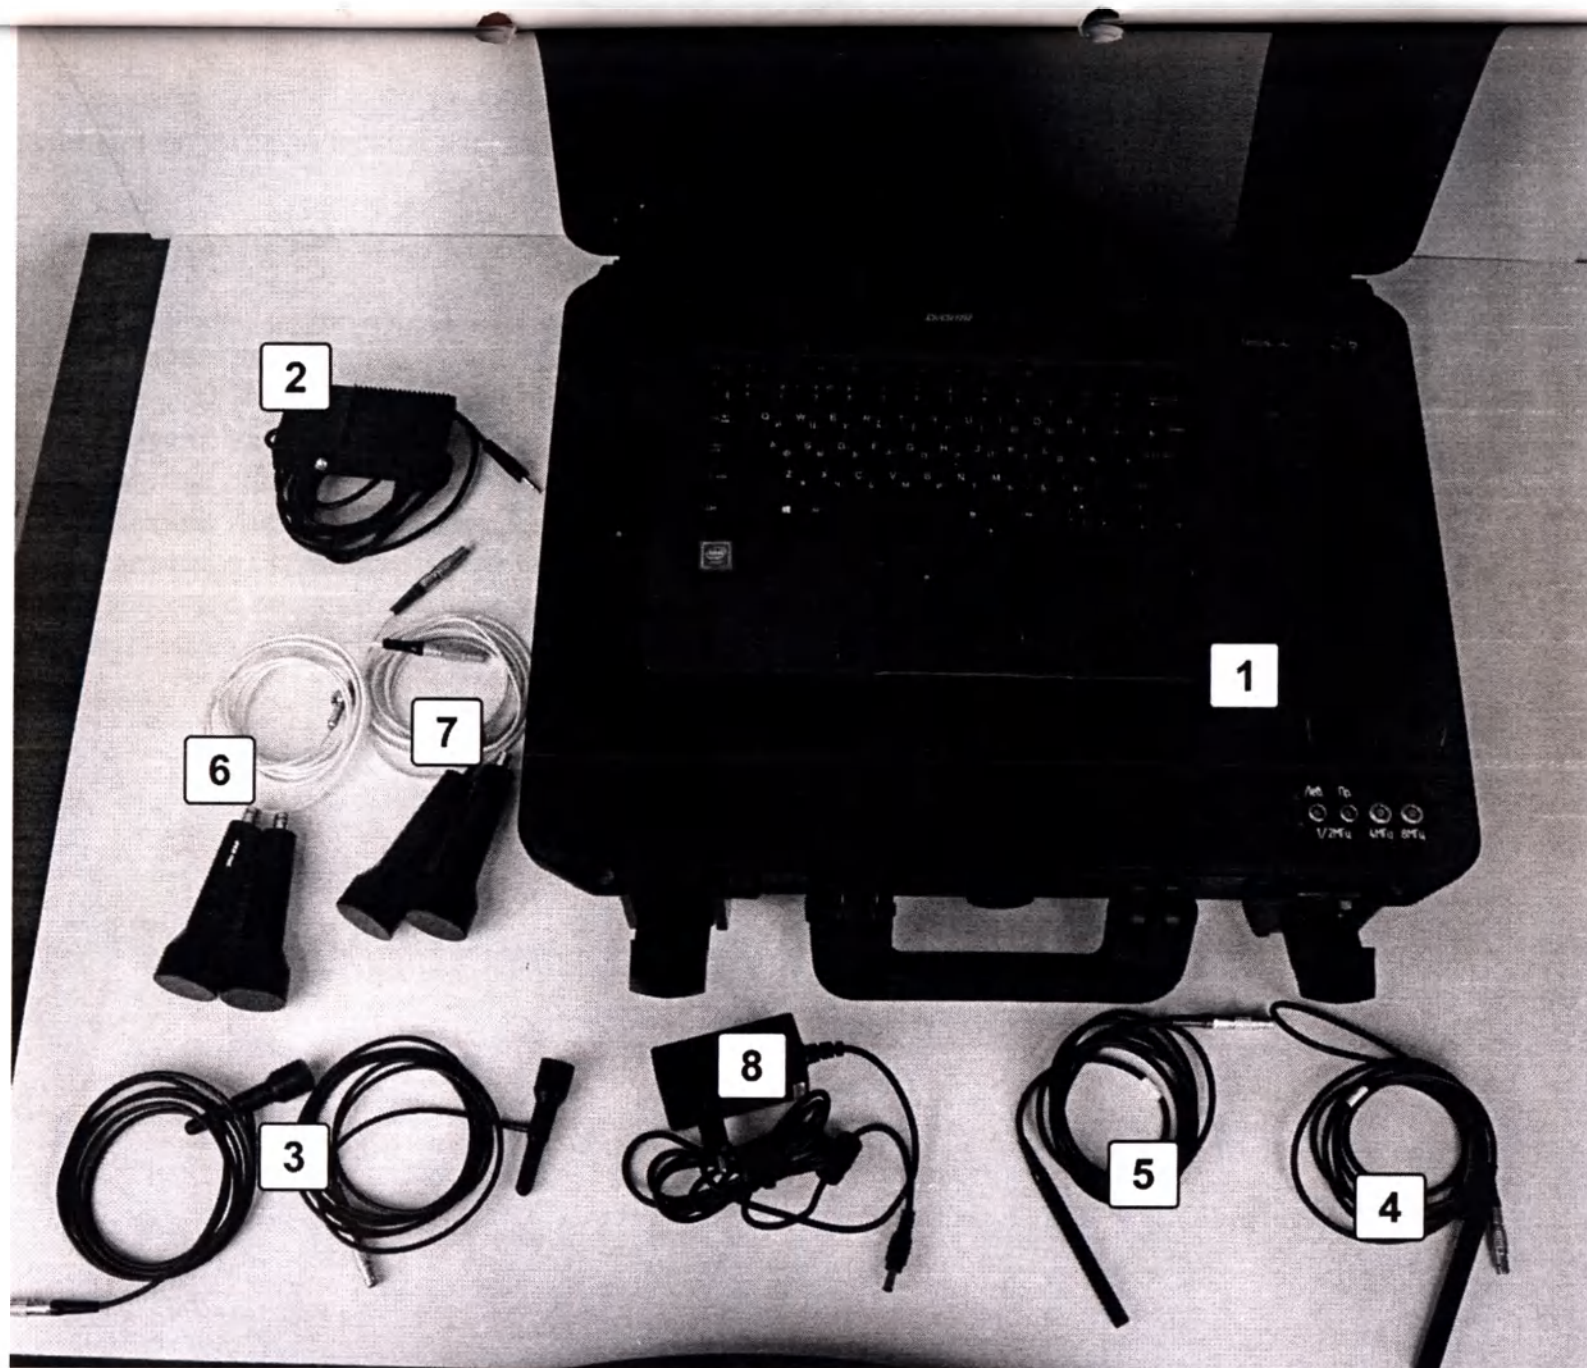

Прибор диагностический ультразвуковой медицинский Комплексмед, исполнение 1.2 общий вид

Обозначения на фотографическом изображении медицинского изделия «Прибор диагностический ультразвуковой медицинский Комплексмед, исполнение 1.2»


1. Чемодан (кейс) со встроенным анализатором доплеровский скорости кровотока с функцией двухканального эхоэнцефалографа и ноутбуком.
2. Педаль ножная.
3. Ультразвуковой датчик для режима импульсного доплера 2 МГц PW.
4. Ультразвуковой датчик для режима непрерывного доплера 4 МГц CW.
5. Ультразвуковой датчик для режима непрерывного доплера 8 МГц CW.
6. Ультразвуковой датчик с соединительным кабелем для режима эхоэнцефалографа 1 МГц.
7. Ультразвуковой датчик с соединительным кабелем для режима эхоэнцефалографа 2 МГц.
8. Медицинский сетевой адаптер.

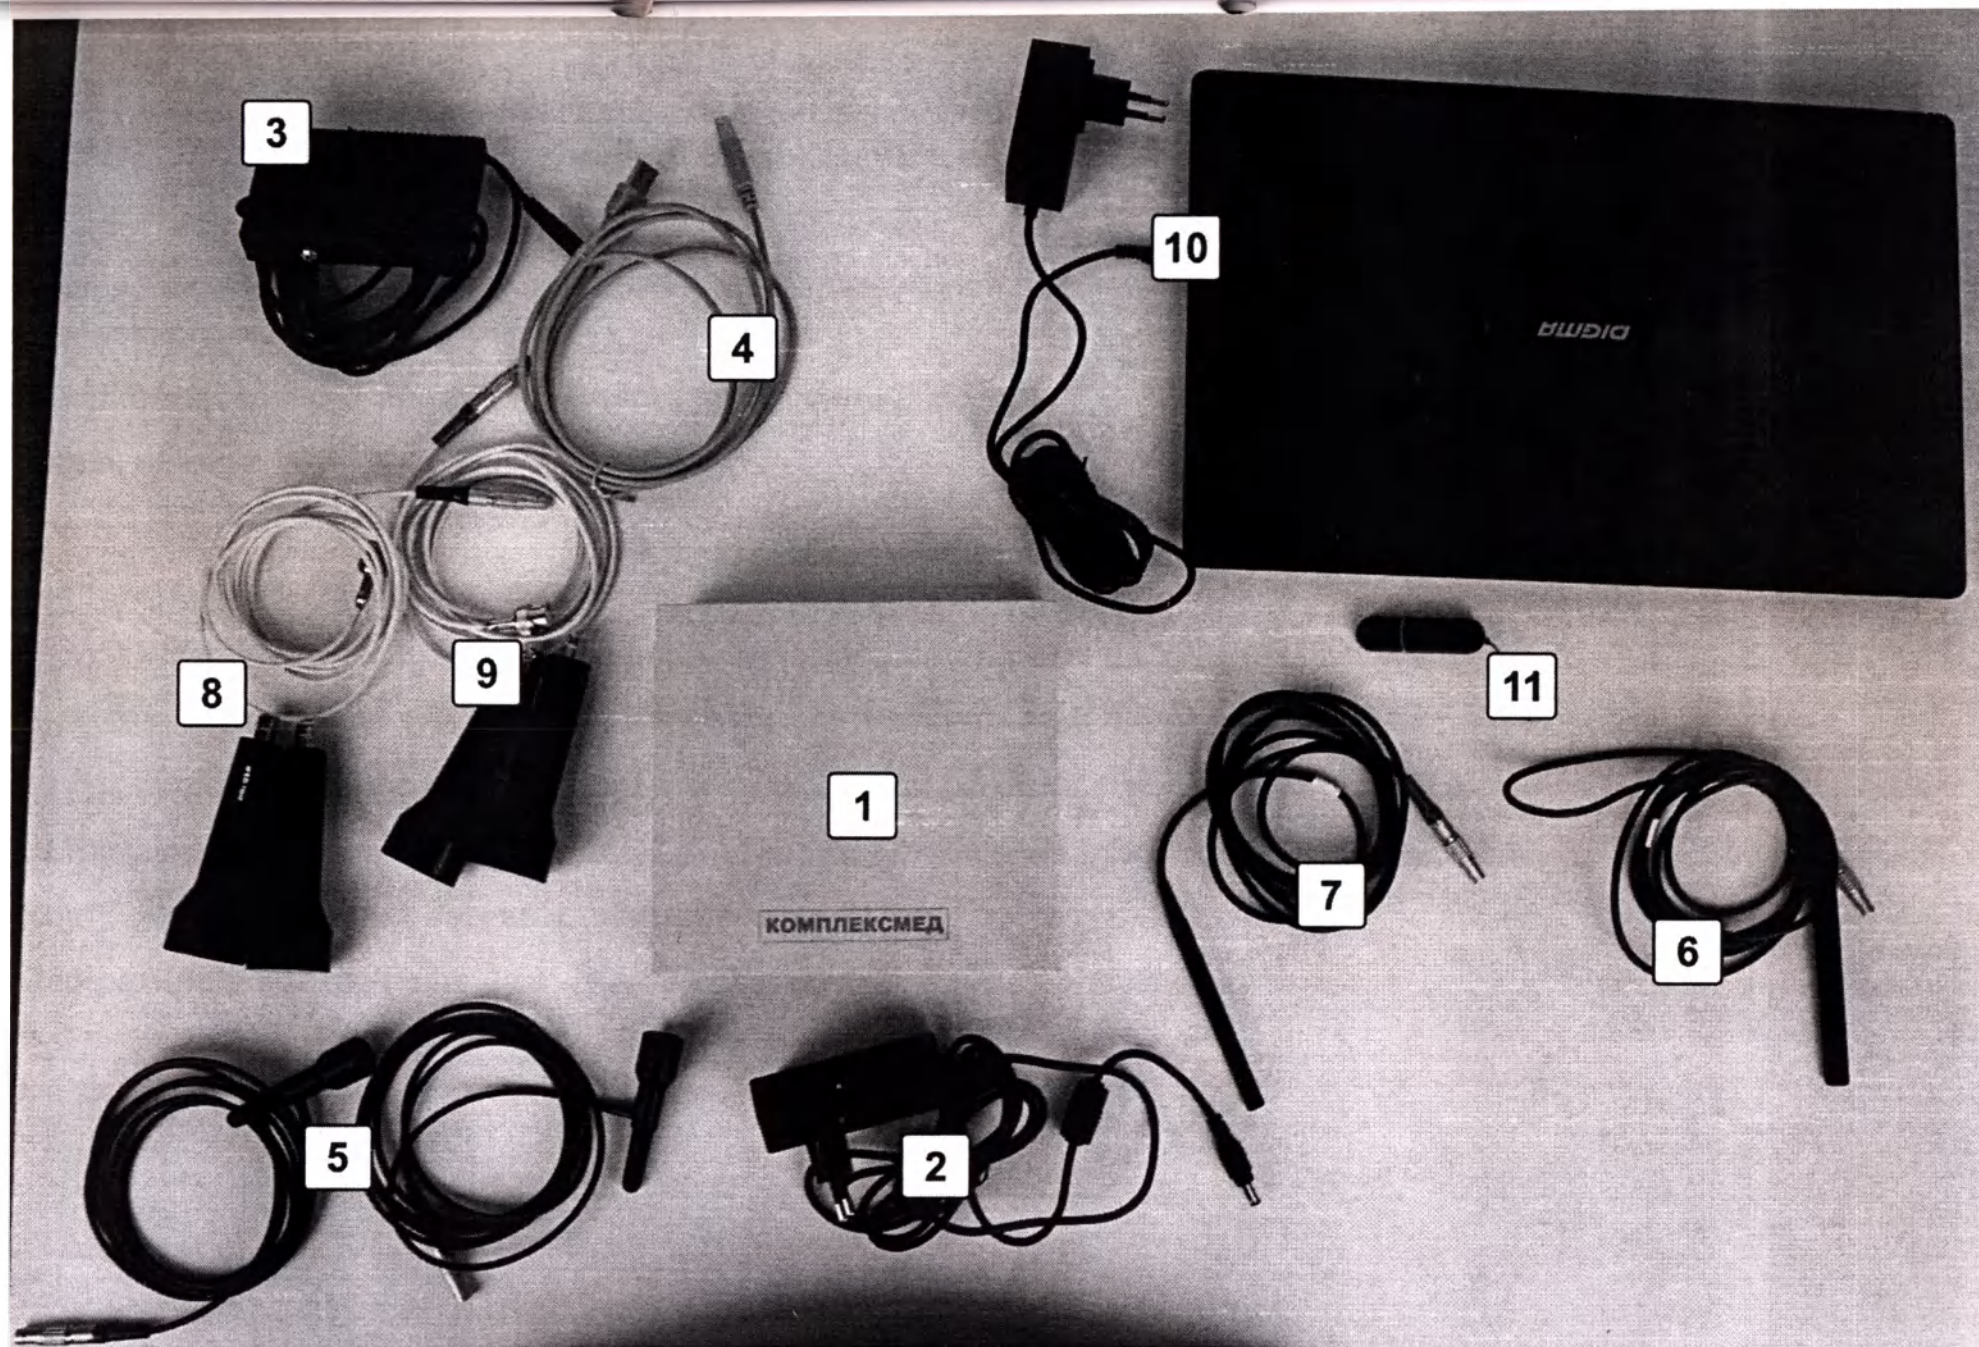

Прибор диагностический ультразвуковой медицинский Комплексмед, исполнение 1.3 общий вид

Обозначения на фотографическом изображении медицинского изделия «Прибор диагностический ультразвуковой медицинский Комплексмед, исполнение 1.3»


1. Внешний электронный модуль анализатора ультразвуковой доплеровский скорости кровотока с функцией двухканального эхоэнцефалографа.
2. Медицинский сетевой адаптер внешнего электронного модуля.
3. Педаль ножная.
4. Кабель USB.
5. Ультразвуковой датчик для режима импульсного доплера 2 МГц PW.
6. Ультразвуковой датчик для режима непрерывного доплера 4 МГц CW.
7. Ультразвуковой датчик для режима непрерывного доплера 8 МГц CW.
8. Ультразвуковой датчик с соединительным кабелем для режима эхоэнцефалографа 1 МГц.
9. Ультразвуковой датчик с соединительным кабелем для режима эхоэнцефалографа 2 МГц.
10. Ноутбук с медицинским сетевым адаптером.
11. Программное обеспечение на съёмном носителе.

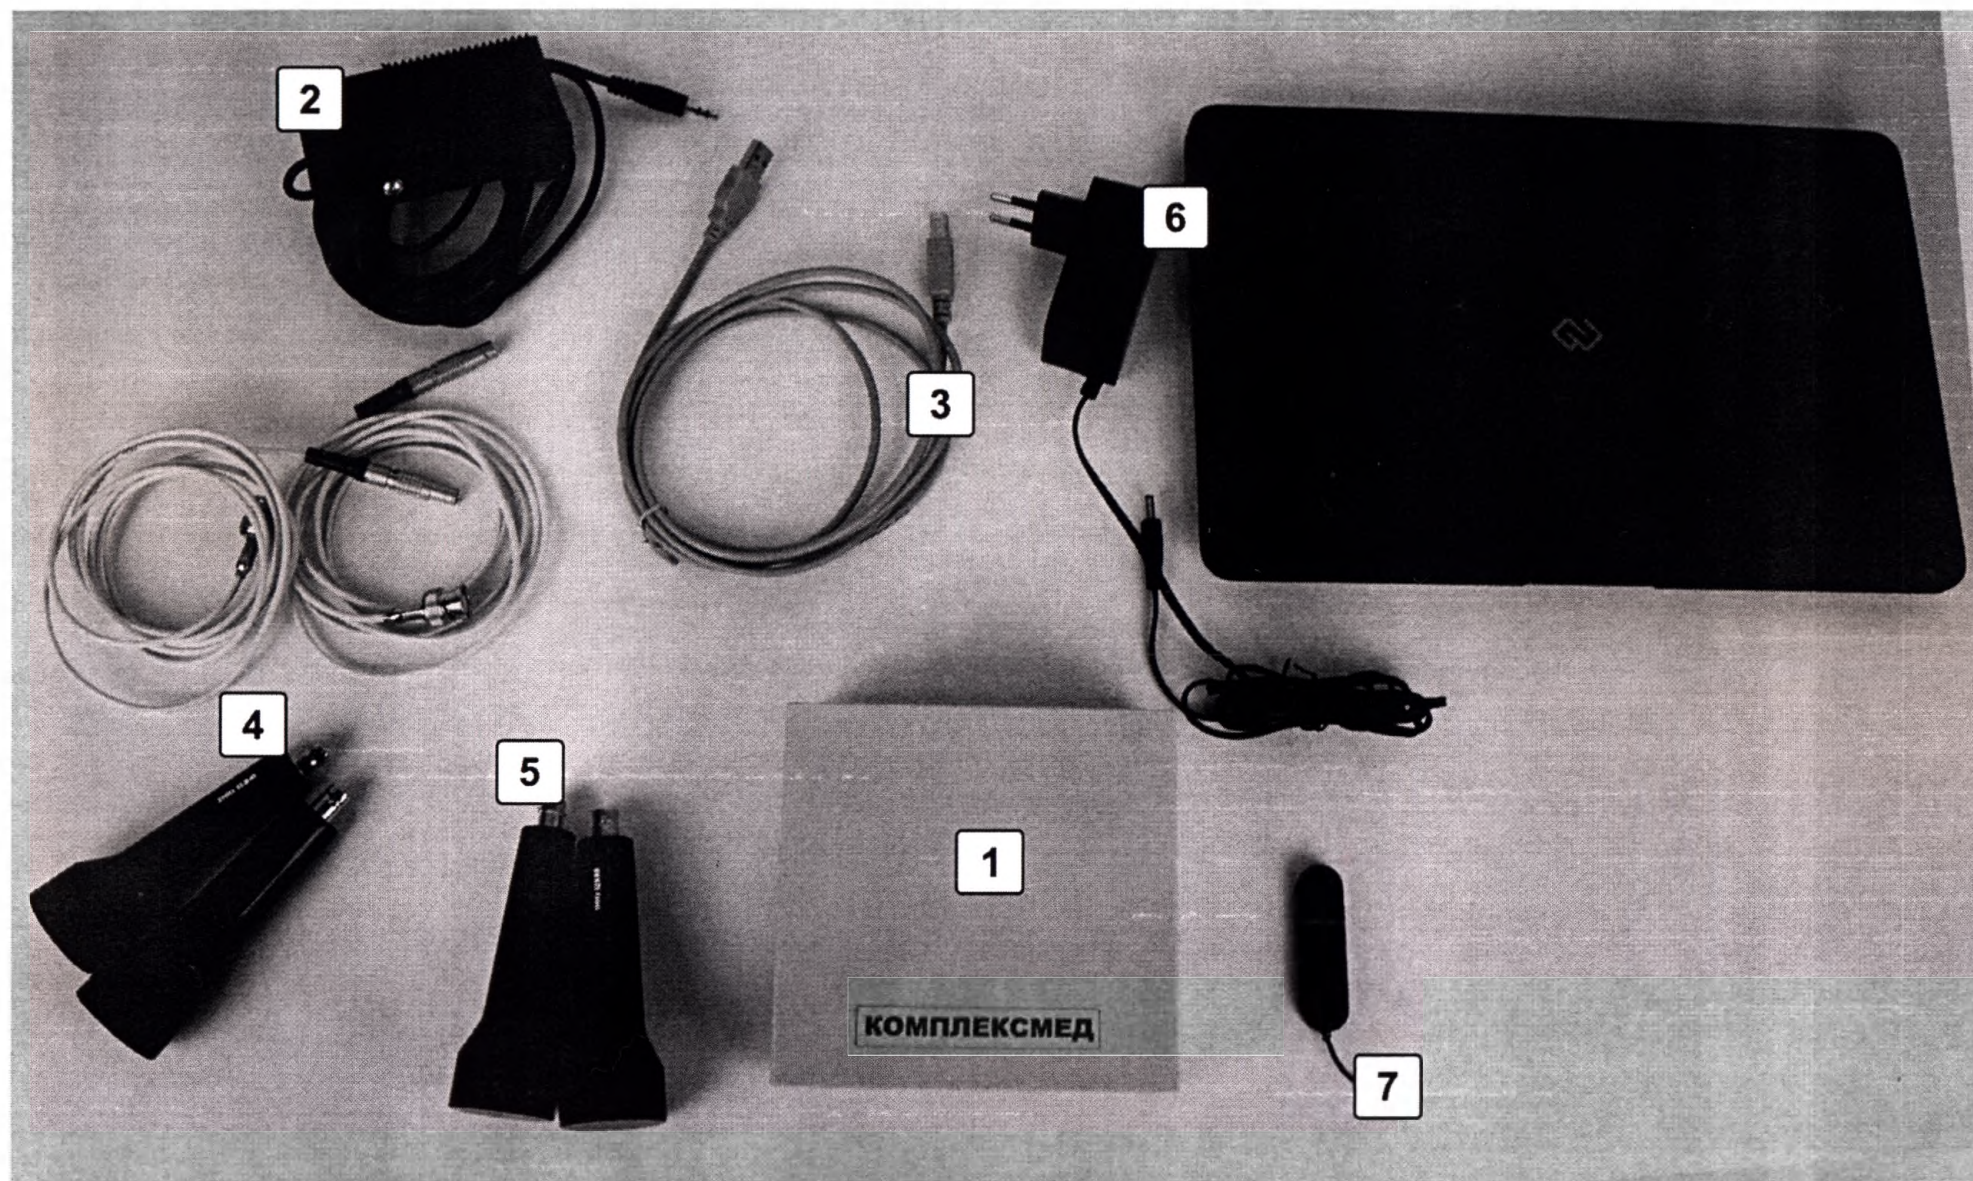

Прибор диагностический ультразвуковой медицинский Комплексмед, исполнение 3.3 общий вид

Обозначения на фотографическом изображении медицинского изделия «Прибор диагностический ультразвуковой
медицинский Комплексмед, исполнение 3.3»

1. Внешний электронный модуль эхоэнцефалографа.
2. Педаль ножная.
3. Кабель USB.
4. Ультразвуковой датчик с соединительным кабелем для режима эхоэнцефалографа 1 МГц.
5. Ультразвуковой датчик с соединительным кабелем для режима эхоэнцефалографа 2 МГц.
6. Ноутбук с медицинским сетевым адаптером.
7. Программное обеспечение на съёмном носителе.

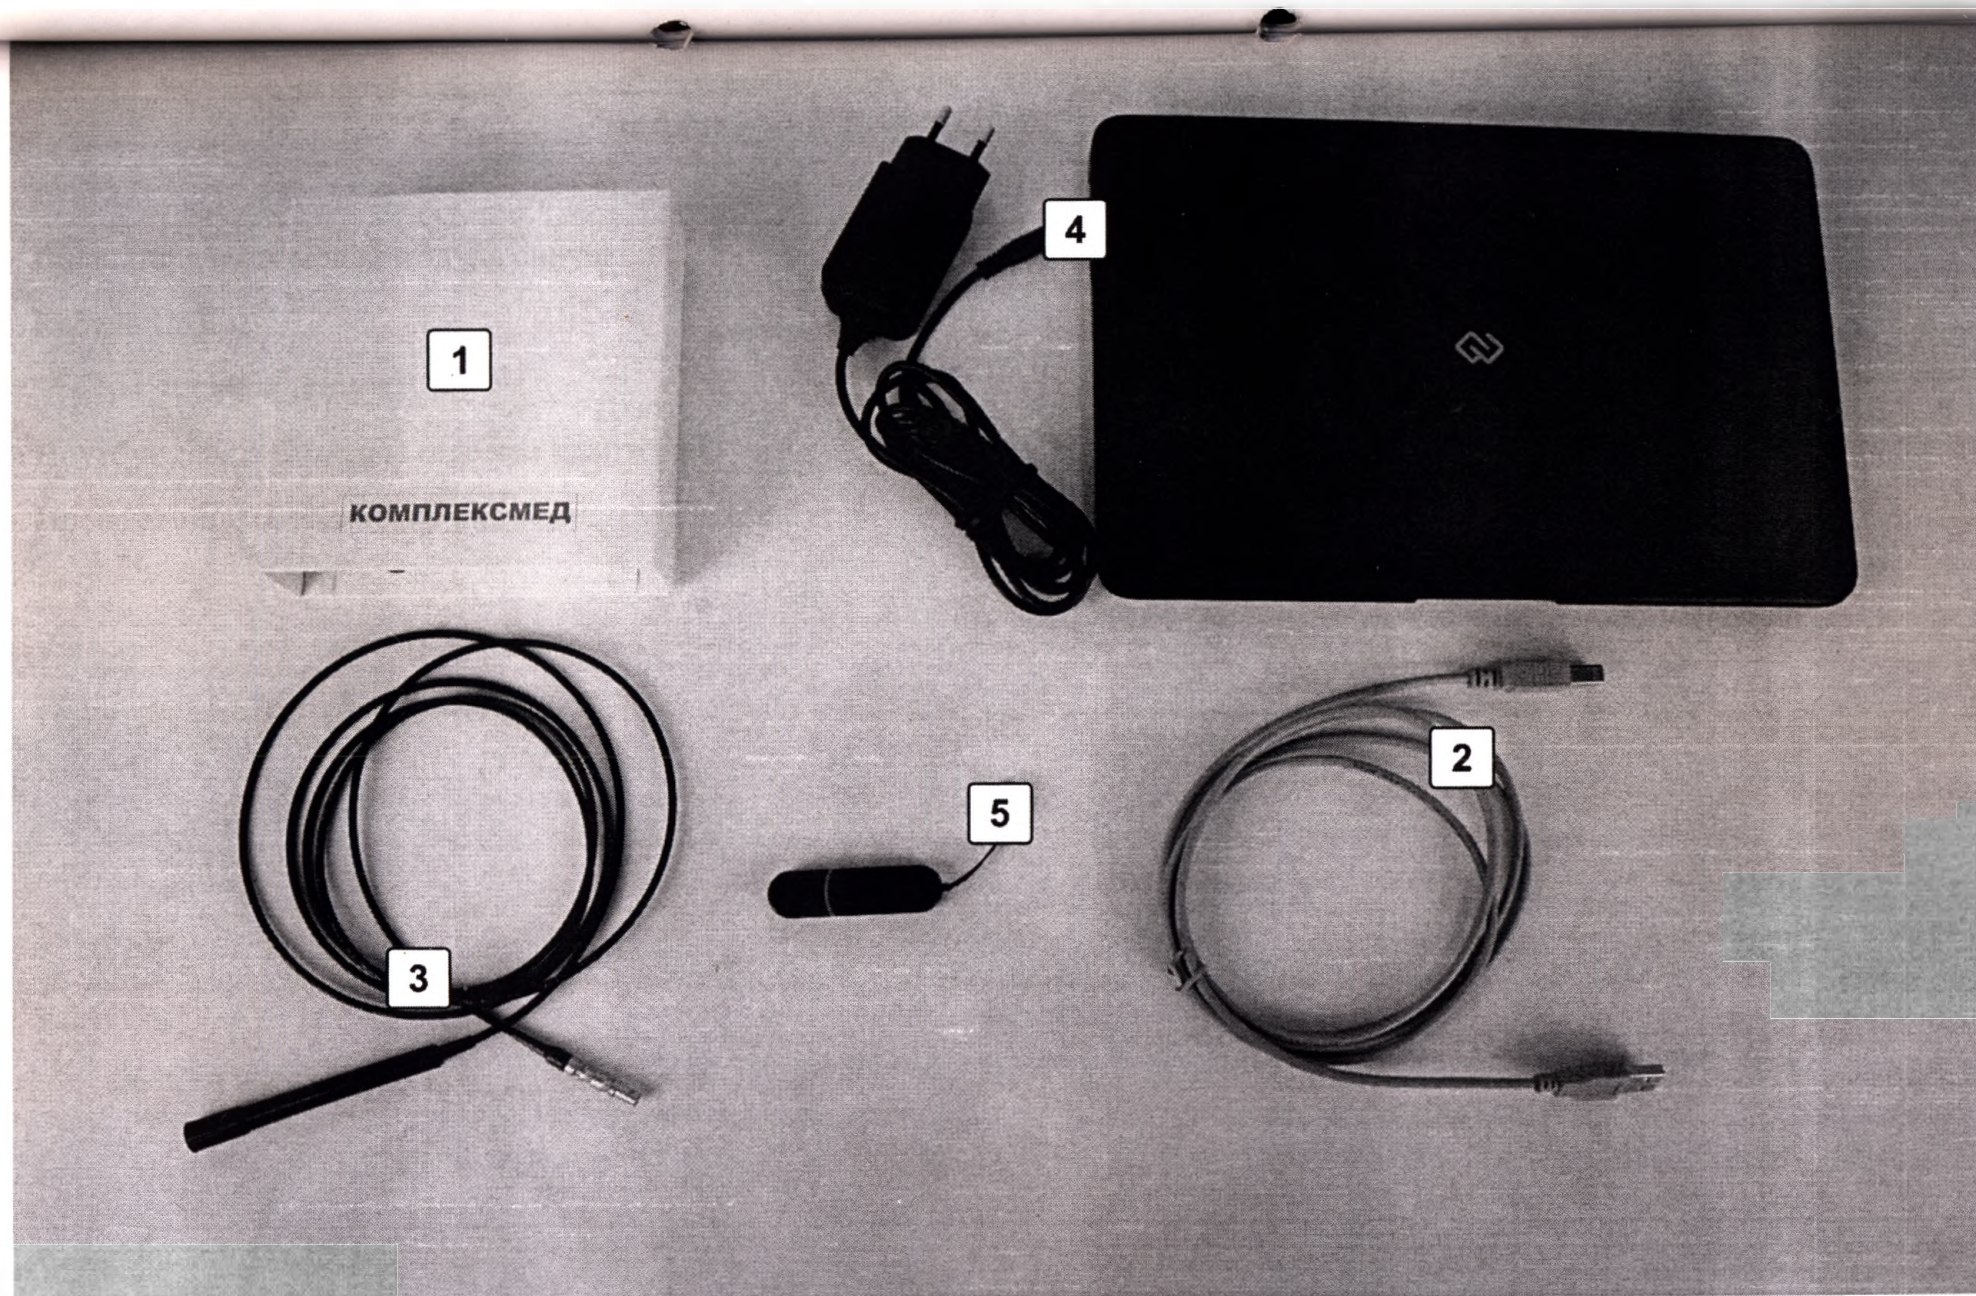


Прибор диагностический ультразвуковой медицинский Комплексмед, исполнение 4.3 общий вид

Обозначения на фотографическом изображении медицинского изделия «Прибор диагностический ультразвуковой
медицинский Комплексмед, исполнение 4.3»

1. Внешний электронный модуль синускопа.
2. Кабель USB.
3. Ультразвуковой датчик 3 МГц.
4. Ноутбук с медицинским сетевым адаптером.
5. Программное обеспечение на съёмном носителе.




Принтер (при необходимости) – распространяется на все варианты исполнений.

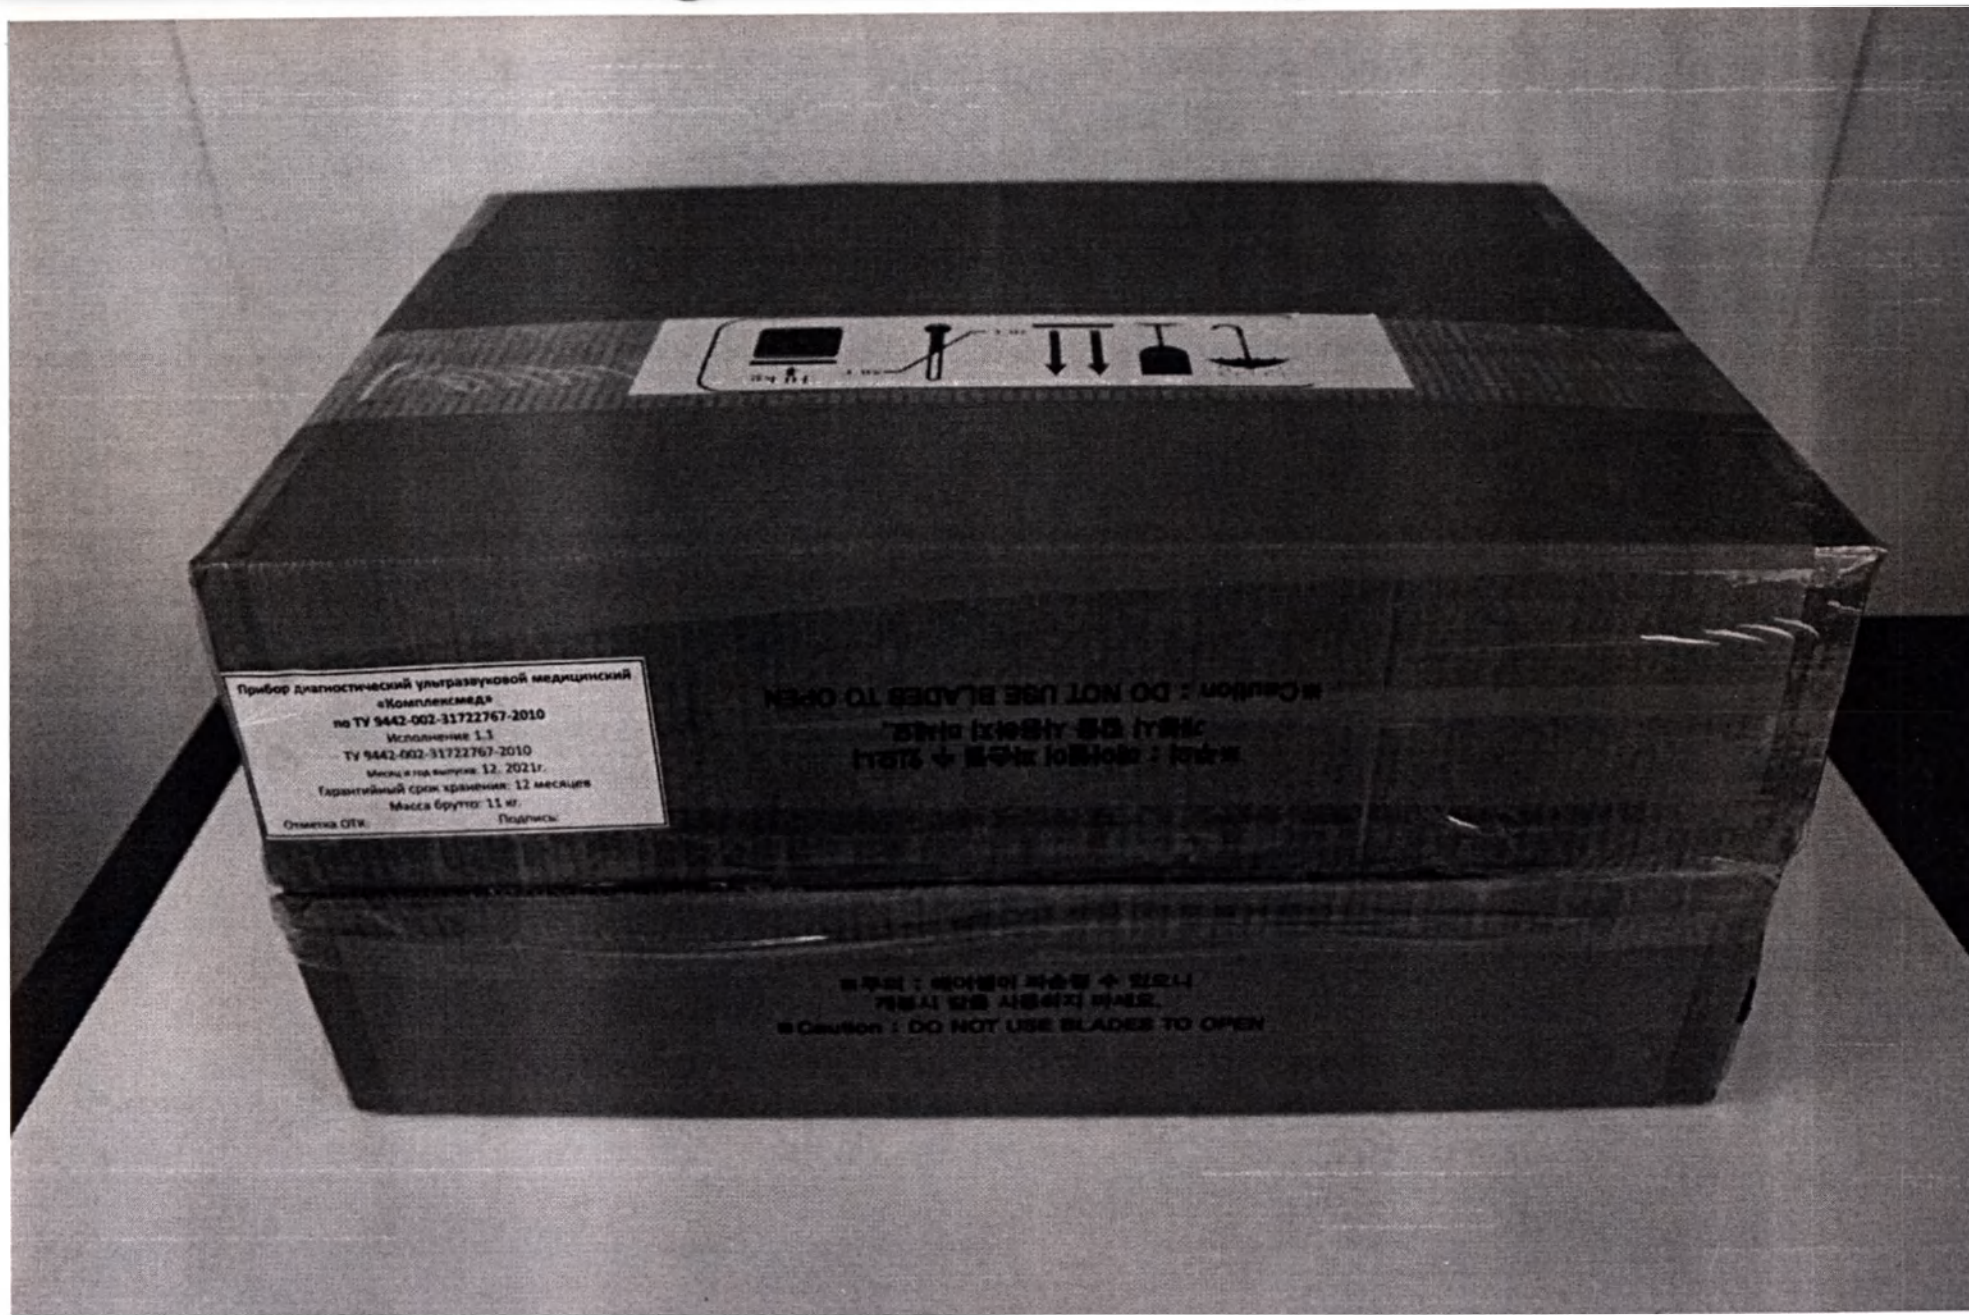

Фотографическое изображение упаковки для исполнения 1.1 .




Фотографическое изображение упаковки для исполнения 1.2

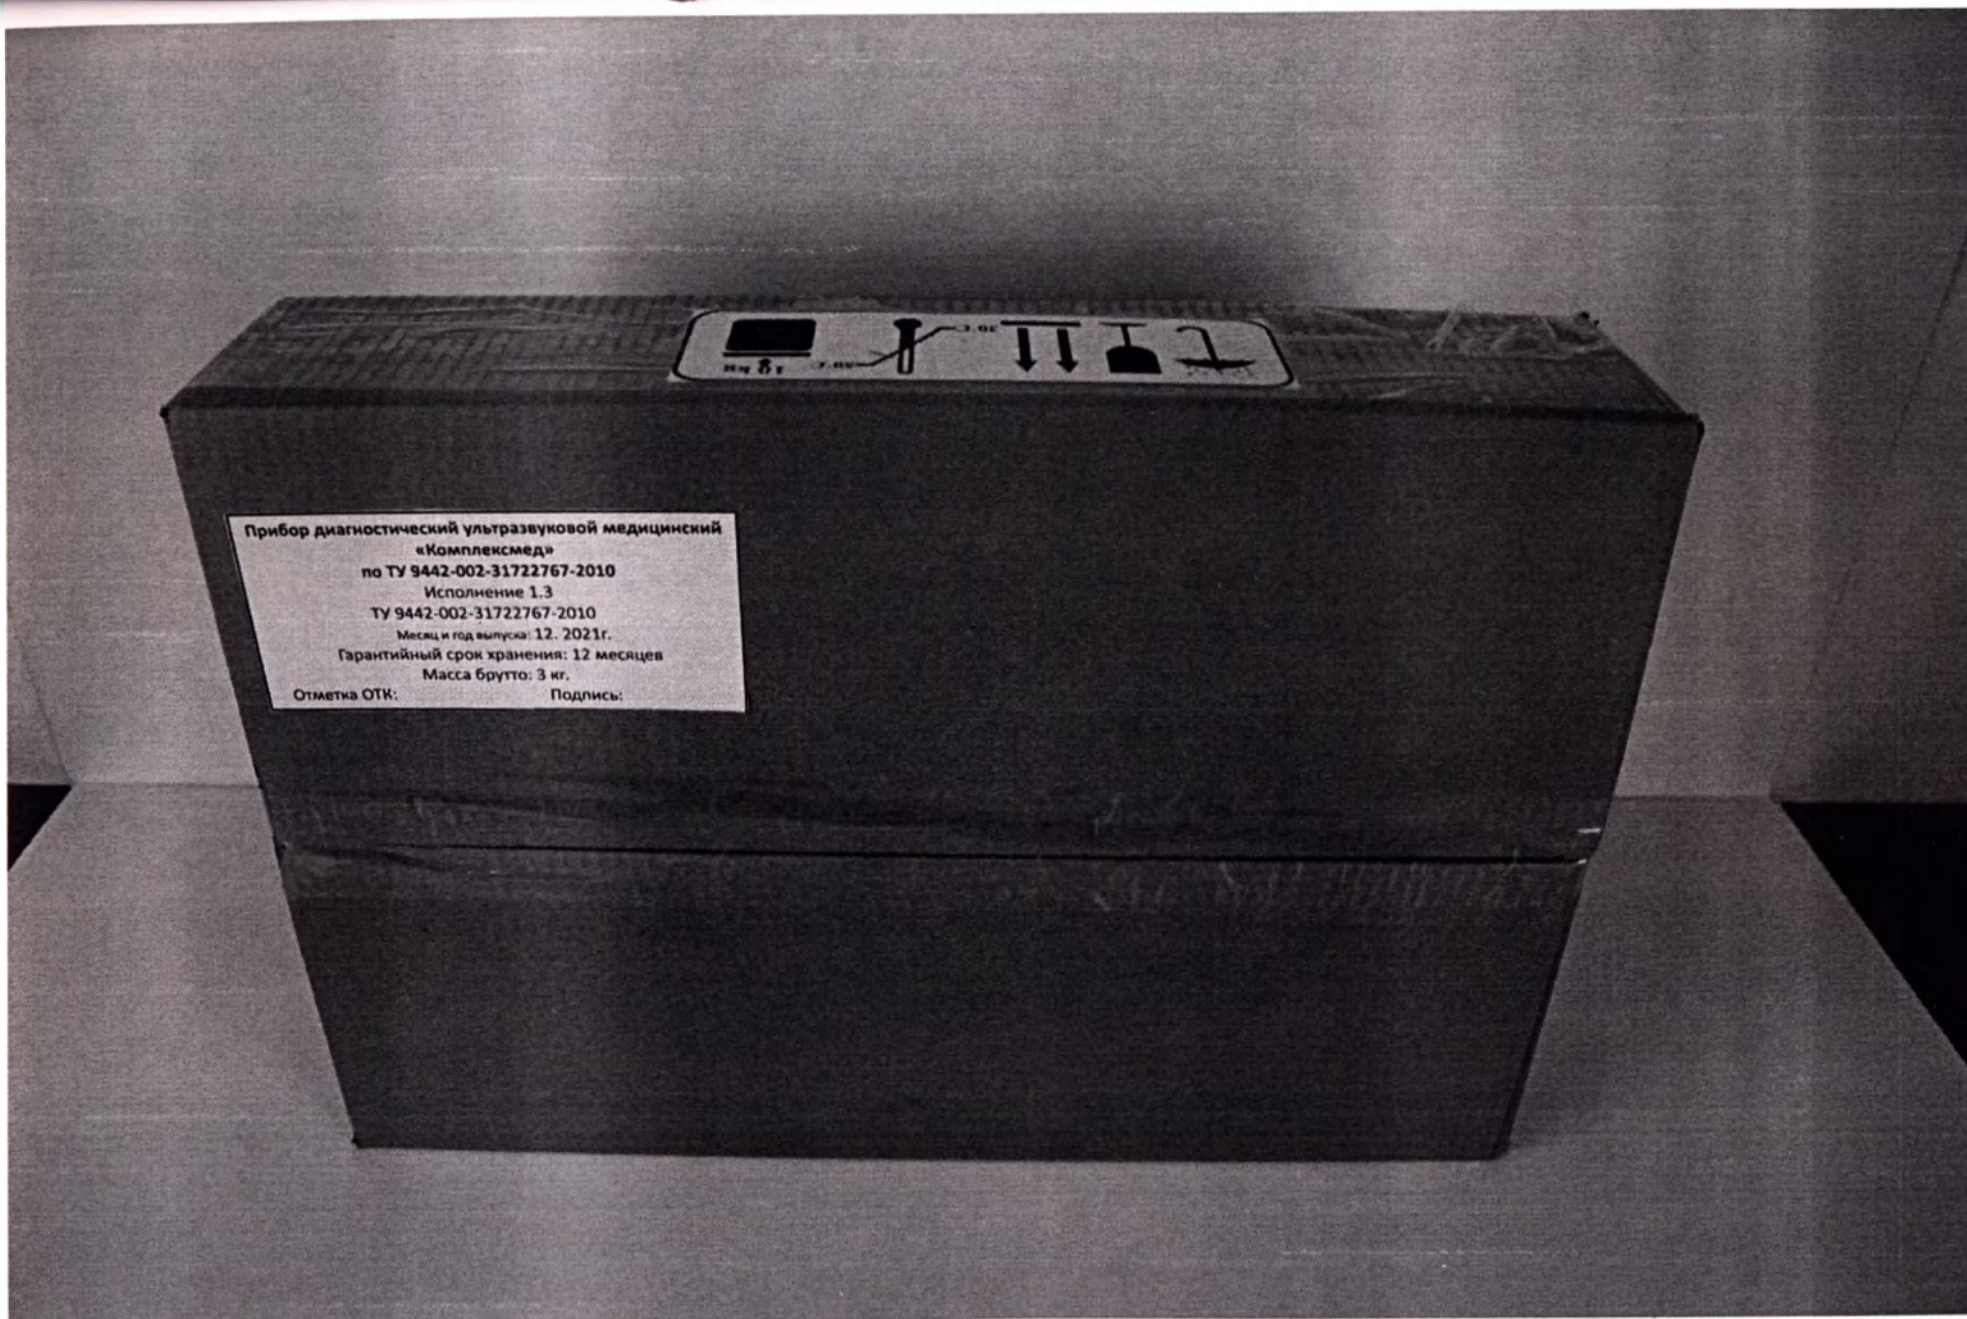


Прибор диагностический ультразвуковой медицинский
«Комплексмед»
по ТУ 9442-002-31722767-2010
Исполнение 1.3
ТУ 9442-002-31722767-2010
Месяц и год выпуска: 12. 2021г.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев
Масса брутто: 3 кг.
Отметка ОТК: _____ Подпись: _____

Фотографическое изображение упаковки для исполнения 1.3

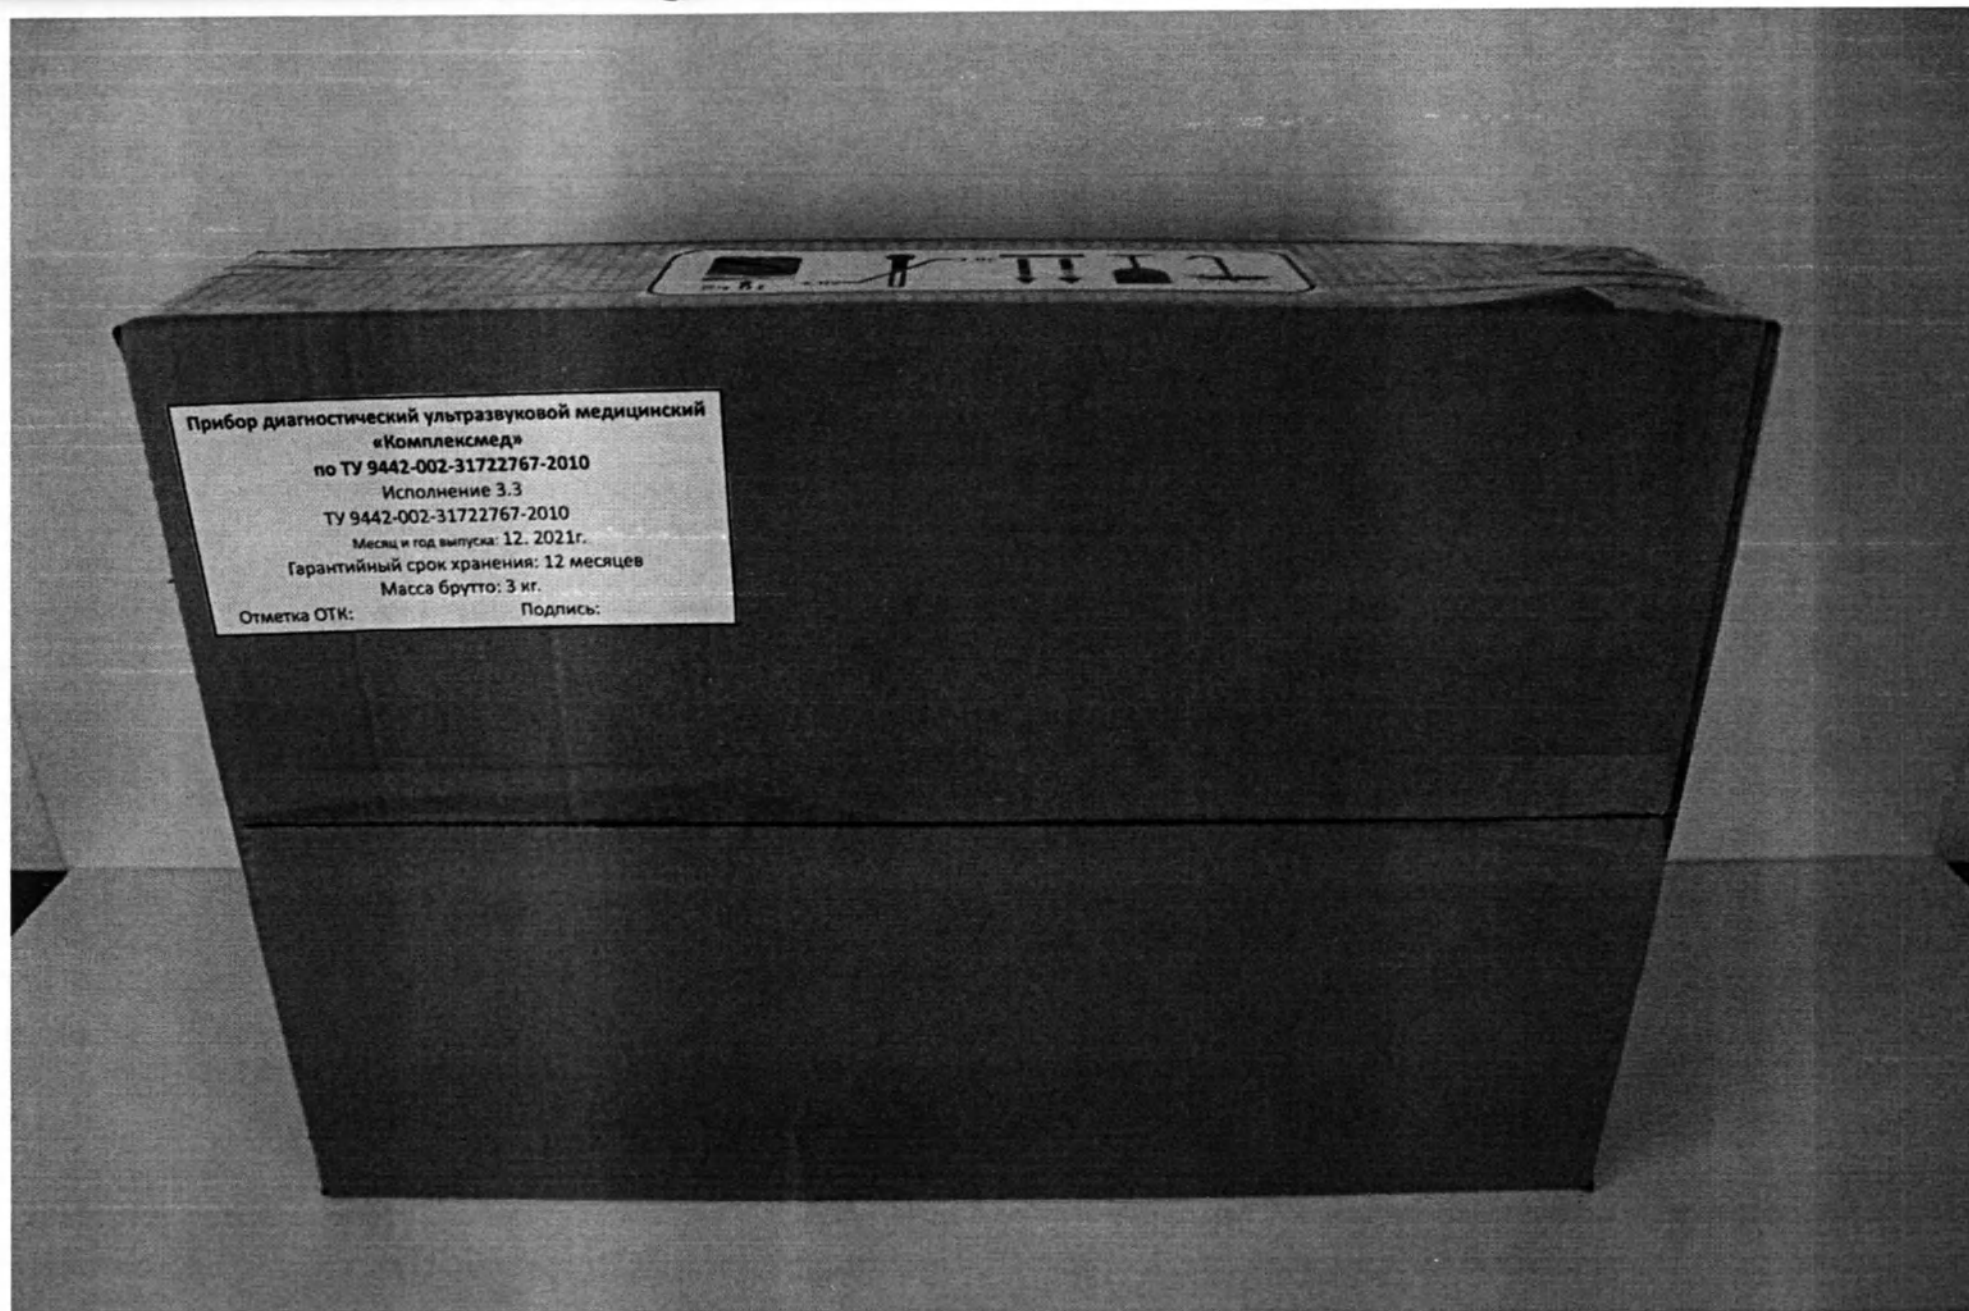

Прибор диагностический ультразвуковой медицинский
«Комплексмед»
по ТУ 9442-002-31722767-2010
Исполнение 3.3
ТУ 9442-002-31722767-2010
Месяц и год выпуска: 12. 2021г.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев
Масса брутто: 3 кг.
Отметка ОТК: _____ Подпись: _____

Фотографическое изображение упаковки для исполнения 3.3

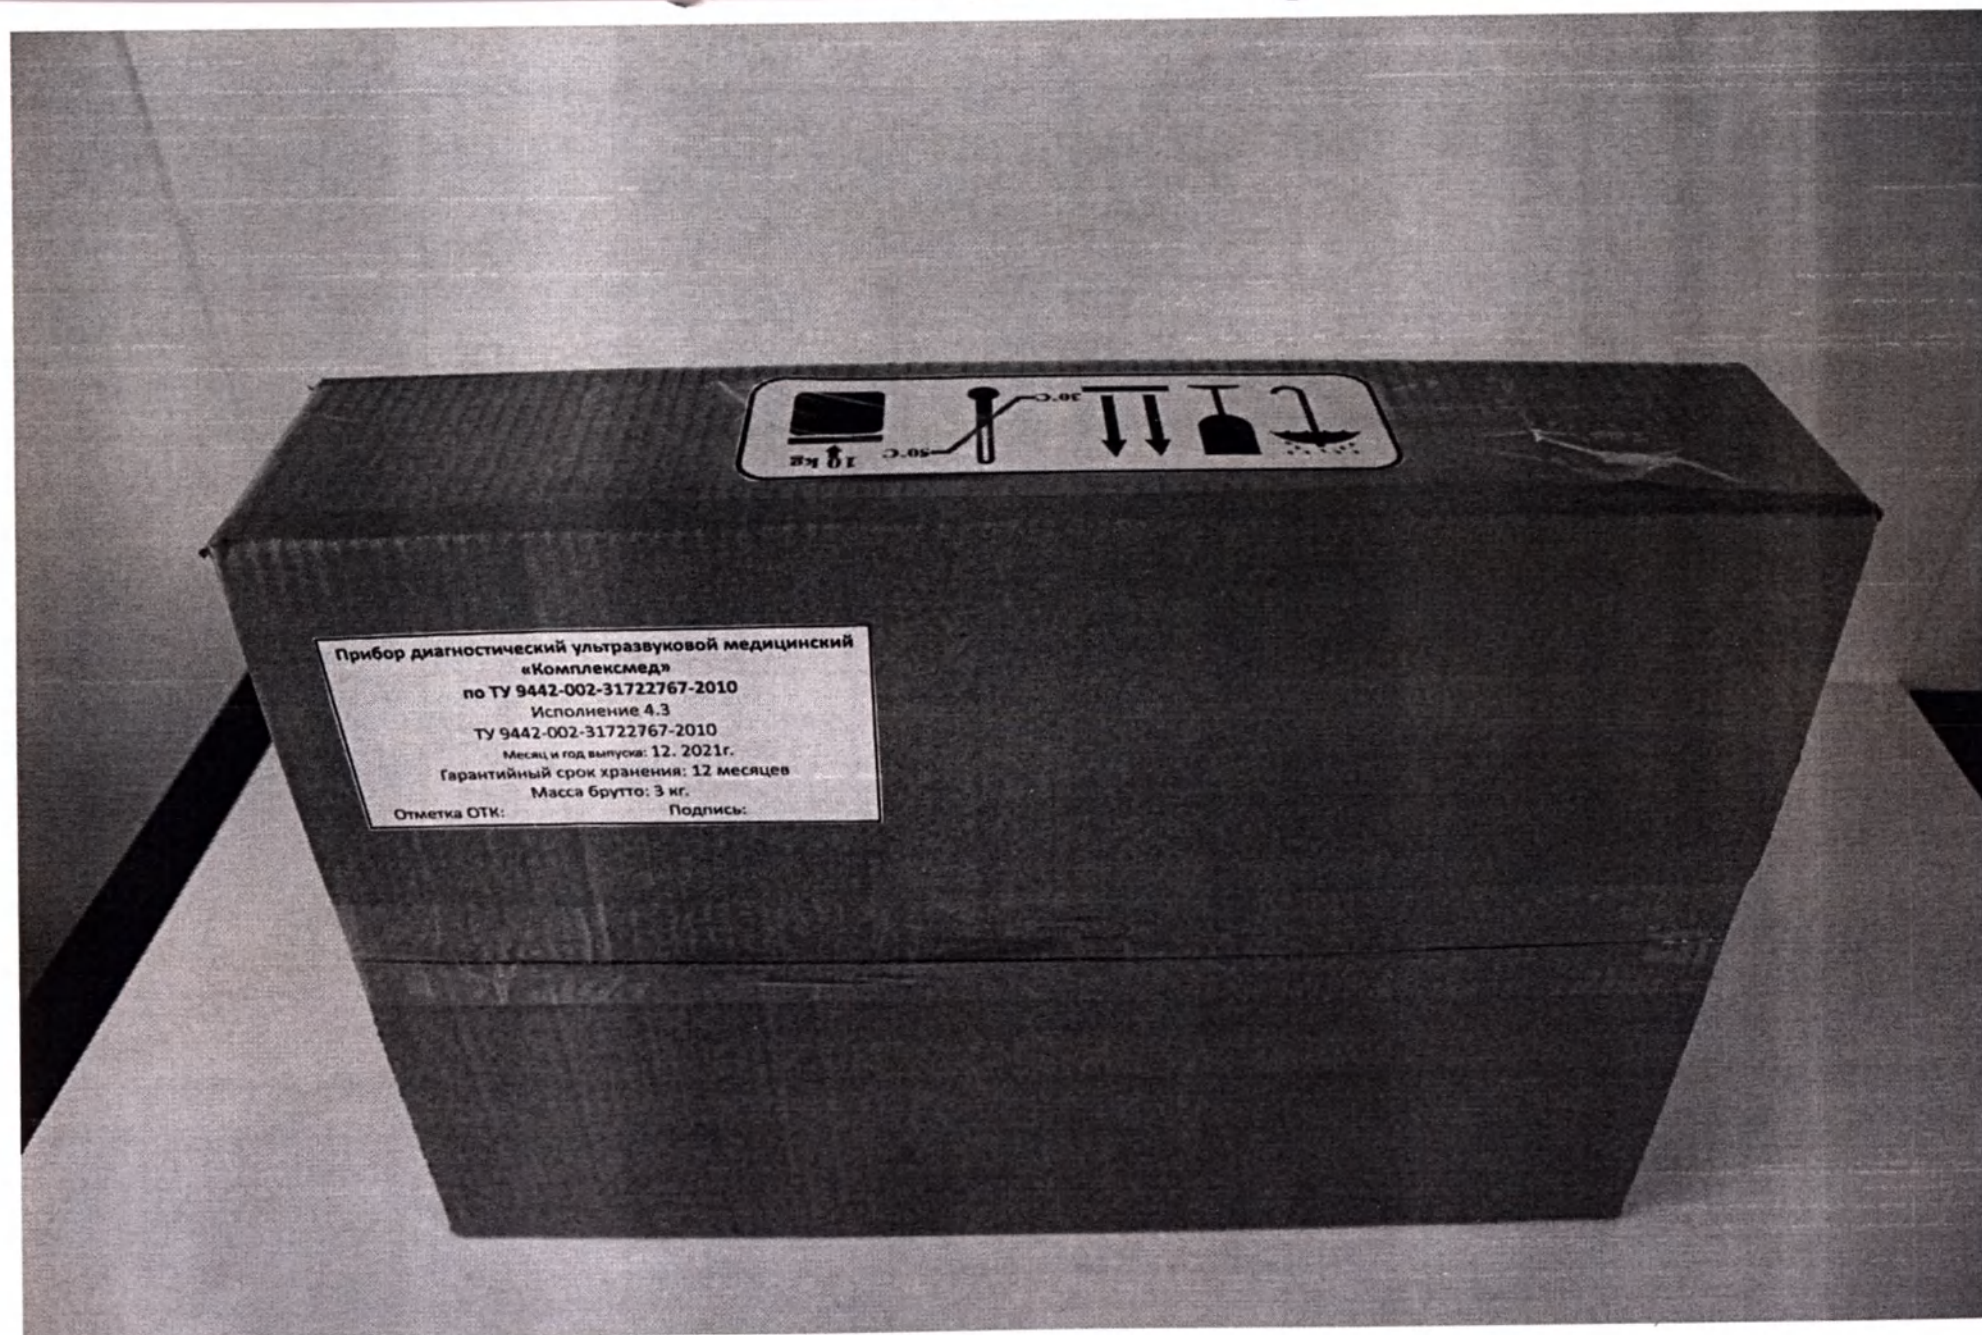

Прибор диагностический ультразвуковой медицинский
«Комплексмед»
по ТУ 9442-002-31722767-2010
Исполнение 4.3
ТУ 9442-002-31722767-2010
Месяц и год выпуска: 12. 2021г.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев
Масса брутто: 3 кг.
Отметка ОТК: Подпись:

Фотографическое изображение упаковки для исполнения 4.3

ООО Инженерный Центр
«Комплекс-М»

Прибор диагностический ультразвуковой
медицинский «Комплексмед»
по ТУ 9442-002-31722767-2010



исполнение 1.1

12В === 5.0А 

Дата выпуска: 12.2021г.
заводской номер: 211.1001

Макет маркировки для исполнения 1.1

**ООО Инженерный Центр
«Комплекс-М»**

**Прибор диагностический ультразвуковой
медицинский «Комплексмед»
по ТУ 9442-002-31722767-2010**



исполнение 1.2

12В — 3.0А  

**Дата выпуска: 12.2021г.
заводской номер: 211.2001**

Макет маркировки для исполнения 1.2

ООО Инженерный Центр
«Комплекс-М»

Прибор диагностический ультразвуковой
медицинский «Комплексмед»
по ТУ 9442-002-31722767-2010



исполнение 1.3

12В === 0.5А  

Дата выпуска: 12.2021г.
заводской номер: 211.3001

Макет маркировки для исполнения 1.3

ООО Инженерный Центр
«Комплекс-М»

Прибор диагностический ультразвуковой
медицинский «Комплексмед»
по ТУ 9442-002-31722767-2010



исполнение 3.3

5В === 0.15А 

Дата выпуска: 12.2021г.
заводской номер: 213.3001

Макет маркировки для исполнения 3.3

ООО Инженерный Центр
«Комплекс-М»

Прибор диагностический ультразвуковой
медицинский «Комплексмед»
по ТУ 9442-002-31722767-2010



исполнение 4.3

5В === 0.15А 

Дата выпуска: 12.2021г.
заводской номер: 214.3001

Макет маркировки для исполнения 4.3

Прибор диагностический ультразвуковой медицинский
«Комплексмед»
по ТУ 9442-002-31722767-2010

Исполнение 1.1



ООО Инженерный Центр «Комплекс-М»
119334 г.Москва ул.Вавилова д.24
Дата выпуска: 07.2022

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев **Масса брутто: 11 кг.**

Отметка ОТК:

Подпись:

Макет маркировки упаковки для исполнения 1.1

Прибор диагностический ультразвуковой медицинский
«Комплексмед»
по ТУ 9442-002-31722767-2010

Исполнение 1.2



ООО Инженерный Центр «Комплекс-М»
119334 г.Москва ул.Вавилова д.24
Дата выпуска: 07.2022

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев **Масса брутто: 6 кг.**

Отметка ОТК:

Подпись:

Макет маркировки упаковки для исполнения 1.2

**Прибор диагностический ультразвуковой медицинский
«Комплексмед»
по ТУ 9442-002-31722767-2010**

Исполнение 1.3



**ООО Инженерный Центр «Комплекс-М»
119334 г.Москва ул.Вавилова д.24
Дата выпуска: 07.2022**

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев Масса брутто: 3 кг.

Отметка ОТК:

Подпись:

Макет маркировки упаковки для исполнения 1.3

**Прибор диагностический ультразвуковой медицинский
«Комплексмед»**

по ТУ 9442-002-31722767-2010

Исполнение 3.3



ООО Инженерный Центр «Комплекс-М»

119334 г.Москва ул.Вавилова д.24

Дата выпуска: 07.2022

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев Масса брутто: 3 кг.

Отметка ОТК:

Подпись:

Макет маркировки упаковки для исполнения 3.3

Прибор диагностический ультразвуковой медицинский
«Комплексмед»
по ТУ 9442-002-31722767-2010

Исполнение 4.3




ООО Инженерный Центр «Комплекс-М»
119334 г.Москва ул.Вавилова д.24
Дата выпуска: 07.2022

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев **Масса брутто: 3 кг.**

Отметка ОТК:

Подпись:

Макет маркировки упаковки для исполнения 4.3

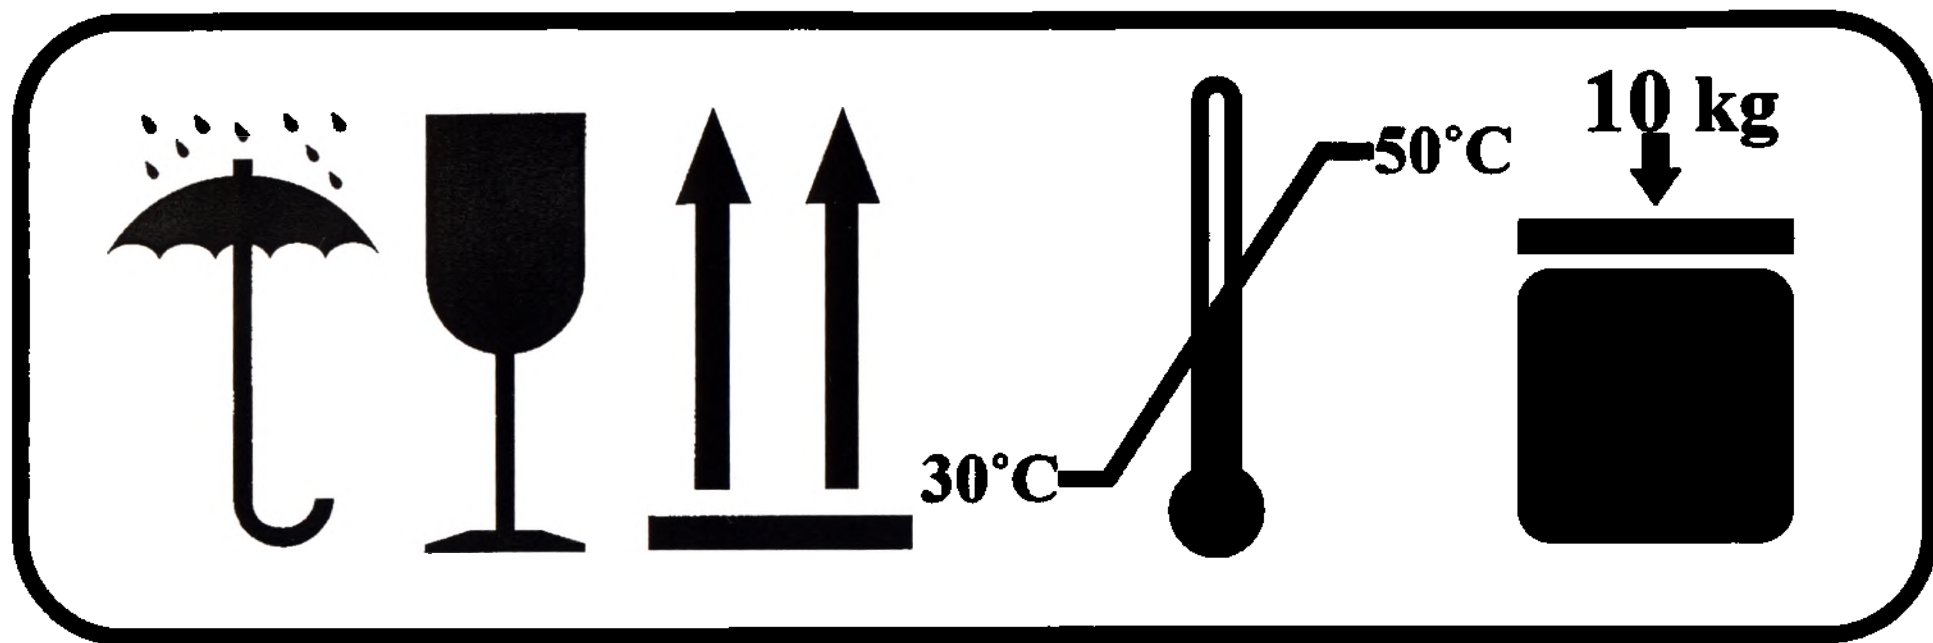

Макет маркировки упаковки медицинского изделия для всех исполнений

Прошито, пронумеровано:

29

лист (ов)

Генеральный директор
ООО Инженерный Центр «Комплекс-М»



 Знайко Г.Г.