

Фотографические изображения изделия

**Роботизированный комплекс для локомоторной терапии и реабилитации
нижних конечностей «NeuroHelper» по ТУ 32.50.50-019-68709709-2022**

ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

Роботизированный комплекс для локомоторной терапии
и реабилитации нижних конечностей «NeuroHelper»
по ТУ 32.50.50-019-68709709-2022

Модификация «Расширенный с ФЭС 16»

Номинальное напряжение питания:	230 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	2.5 кВт·А



Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)



При работе необходимо обеспечить свободный доступ
воздуха к вентиляционным отверстиям

Заводской номер:


001




08 2022

IP10



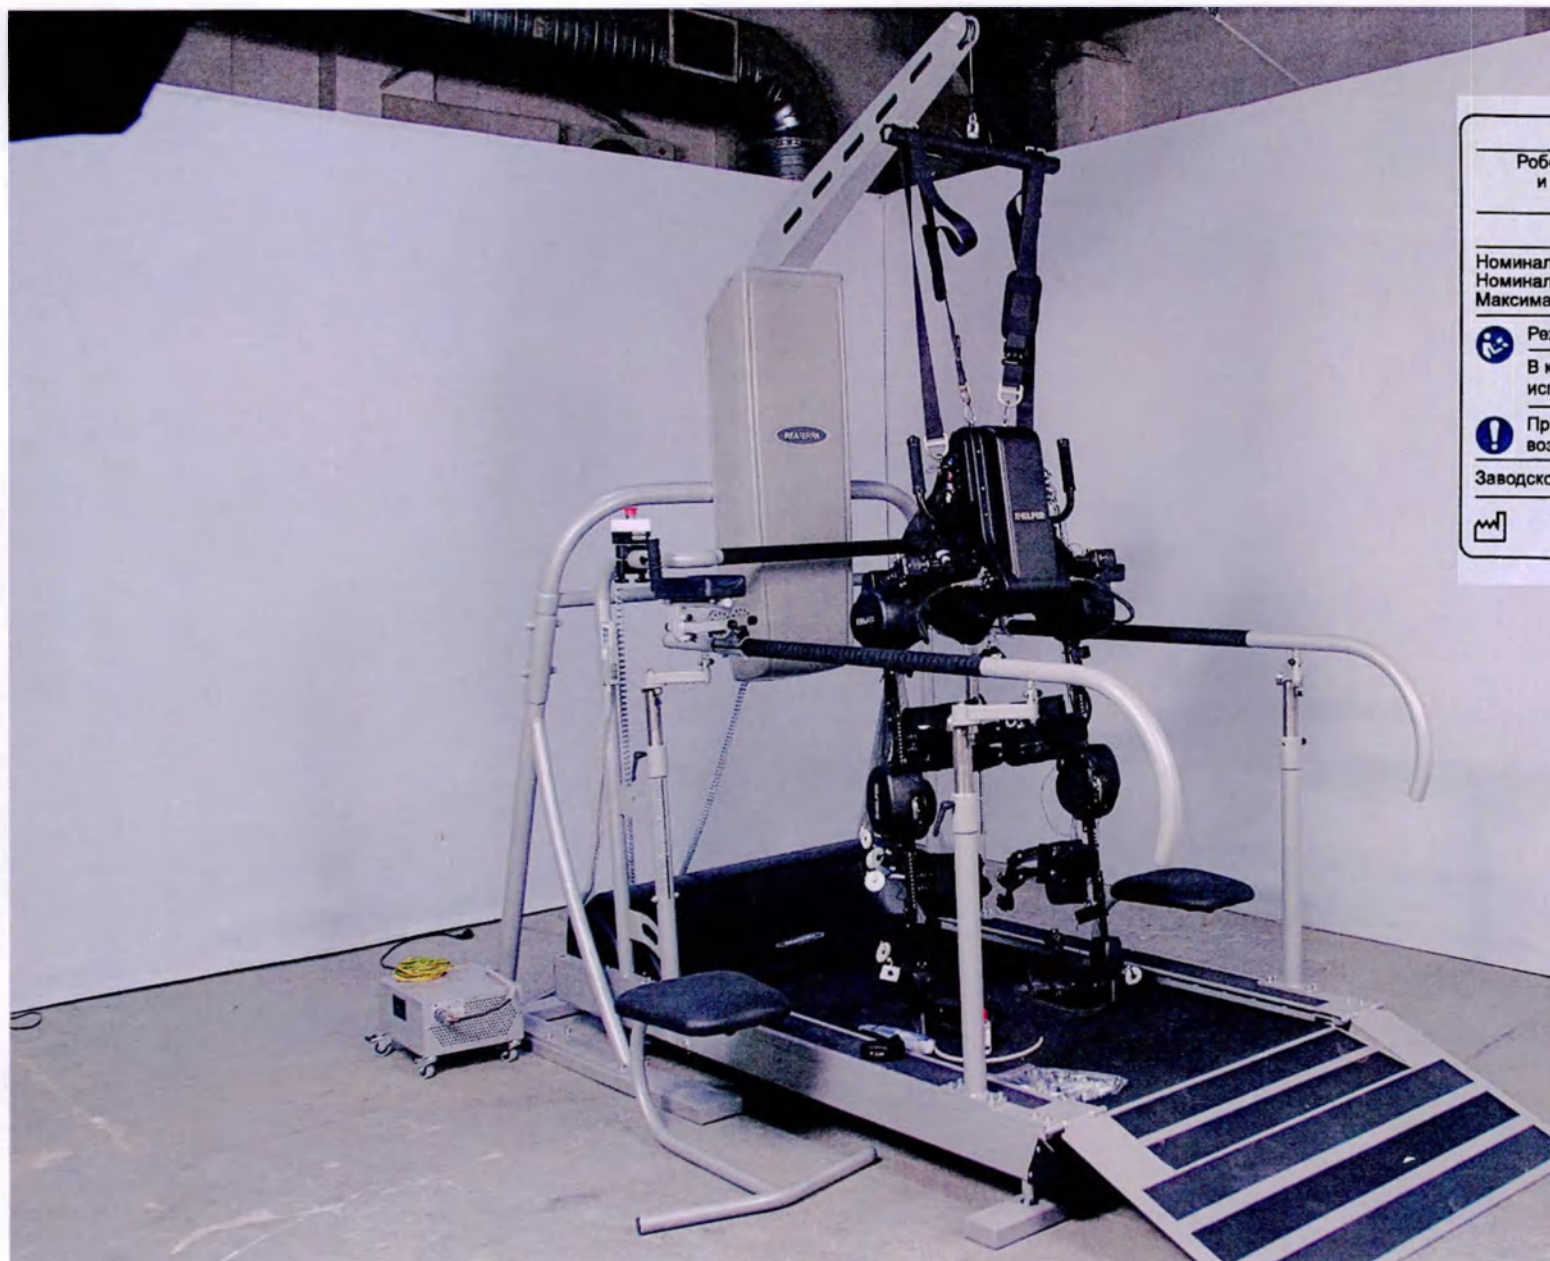

ООО НПФ «Реабилитационные технологии»	
Роботизированный комплекс для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей «NeuroHelper» по ТУ 32.50.50-019-68709709-2022	
Модификация «Стандартный»	
Номинальное напряжение питания:	230 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	2.5 кВт·А
 Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)	
 В качестве резервного источника питания системы разгрузки используются свинцово-кислотные аккумуляторы	
 При работе необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям	
Заводской номер:	
    	

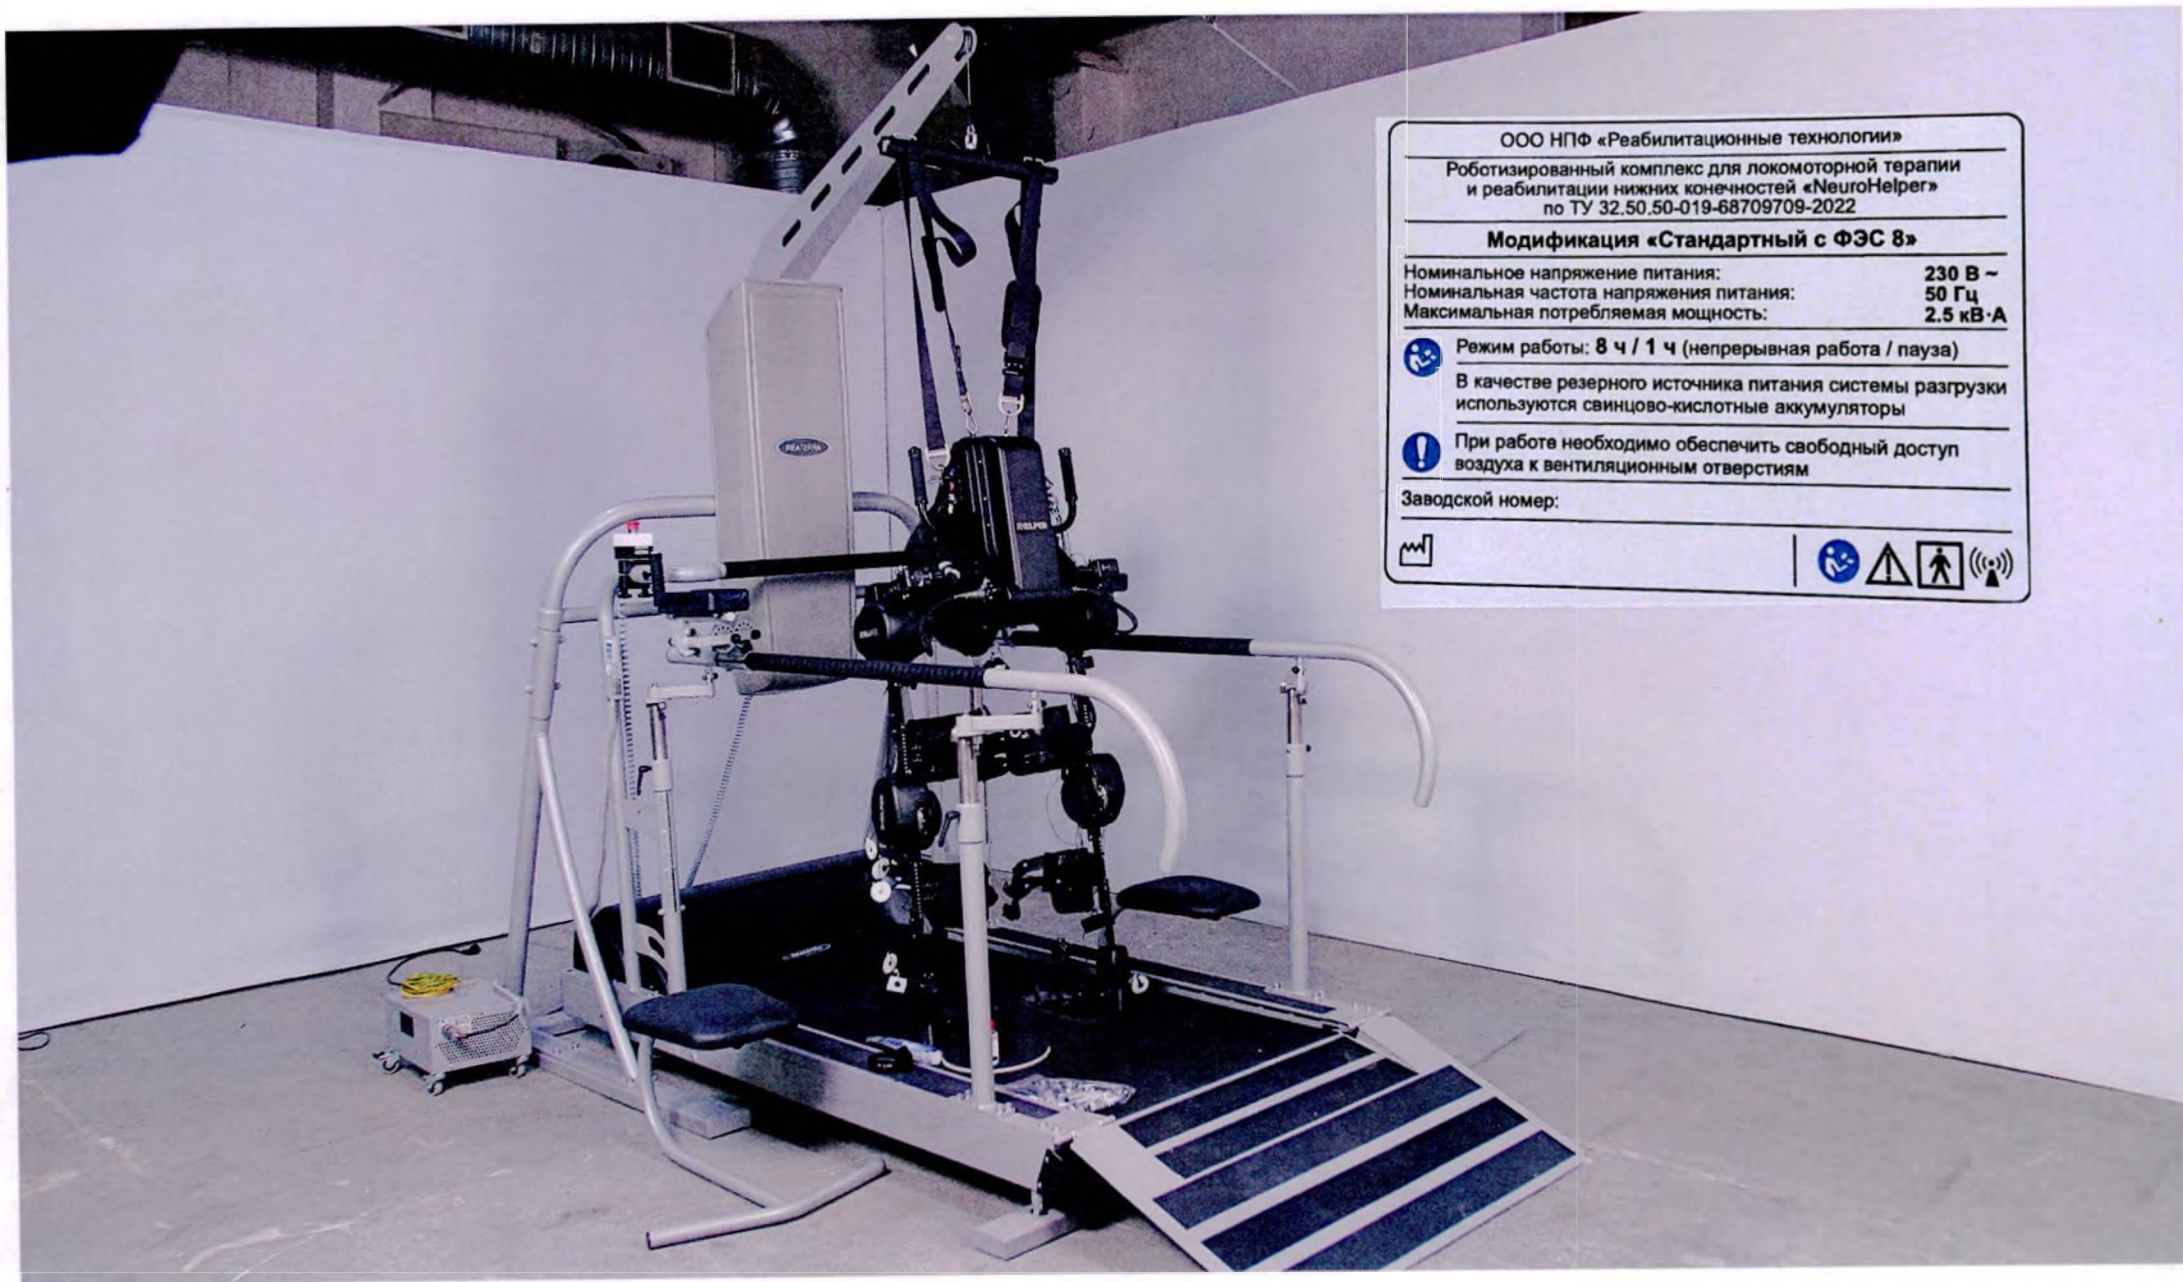

ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

Роботизированный комплекс для локомоторной терапии
и реабилитации нижних конечностей «NeuroHelper»
по ТУ 32.50.50-019-68709709-2022

Модификация «Стандартный с ФЭС 8»

Номинальное напряжение питания:	230 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	2.5 кВт·А


 Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)

В качестве резервного источника питания системы разгрузки
используются свинцово-кислотные аккумуляторы

 При работе необходимо обеспечить свободный доступ
воздуха к вентиляционным отверстиям

Заводской номер:



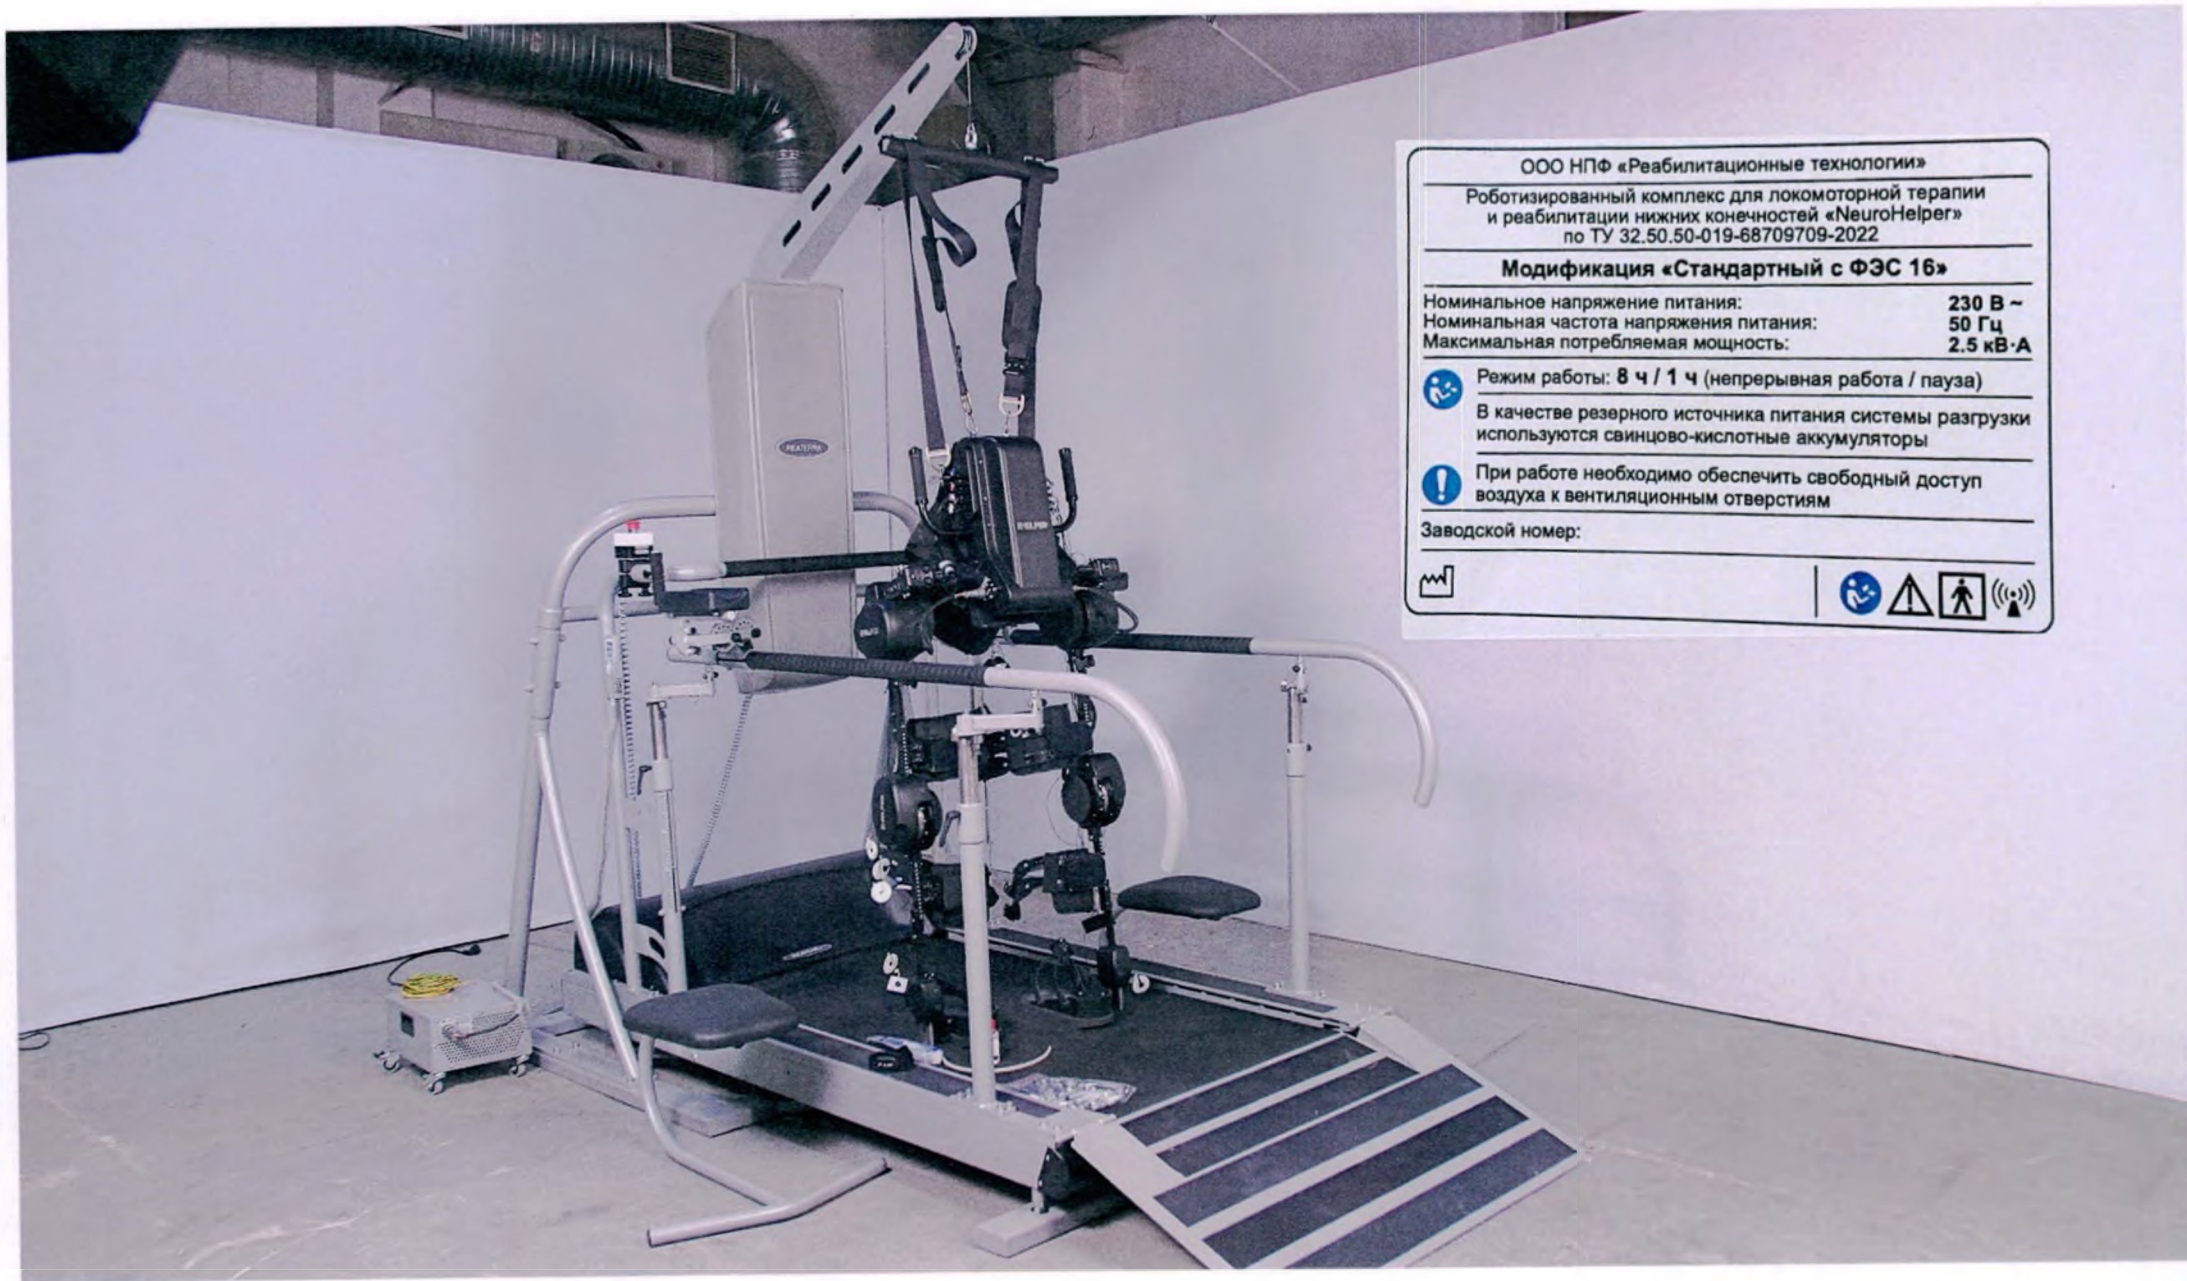

ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

Роботизированный комплекс для локомоторной терапии
и реабилитации нижних конечностей «NeuroHelper»
по ТУ 32.50.50-019-68709709-2022

Модификация «Стандартный с ФЭС 16»

Номинальное напряжение питания:	230 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	2.5 кВт·А

 Режим работы: **8 ч / 1 ч** (непрерывная работа / пауза)

В качестве резервного источника питания системы разгрузки
используются свинцово-кислотные аккумуляторы

 При работе необходимо обеспечить свободный доступ
воздуха к вентиляционным отверстиям

Заводской номер:





ООО НПФ «Реабилитационные технологии»	
Роботизированный комплекс для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей «NeuroHelper» по ТУ 32.50.50-019-68709709-2022	
Модификация «Расширенный»	
Номинальное напряжение питания:	230 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	2.5 кВт·А
	Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)
	При работе необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям
Заводской номер:	
	   



ООО НПФ «Реабилитационные технологии»	
Роботизированный комплекс для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей «NeuroHeleg» по ТУ 32.50.50-019-68709709-2022	
Модификация «Расширенный с ФЭС 8»	
Номинальное напряжение питания:	230 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	2.5 кВт·А
⚙️	Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)
⚠️	При работе необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям
Заводской номер:	
🔌	⚠️ ⚡ ⚠️ 🚫 📶



ООО НПФ «Реабилитационные технологии»
 Роботизированный комплекс для локомоторной терапии
 и реабилитации нижних конечностей «NeuroHelper»
 по ТУ 32.50.50-019-68709709-2022

Модификация «Расширенный с ФЭС 16»

Номинальное напряжение питания:	230 В ~
Номинальная частота напряжения питания:	50 Гц
Максимальная потребляемая мощность:	2.5 кВт·А

Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)

При работе необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям

Заводской номер:

⚠️ ⚡ ⚠️ ⚠️

Экзоскелет




Режим работы: рабочий цикл 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)
С периодичностью 45 мин / 15 мин (работа / перерыв)

Изделие с внутренним источником питания

Параметры зарядного устройства: $\approx 43.8 \text{ В} / 1.65 \text{ А}$

IP10

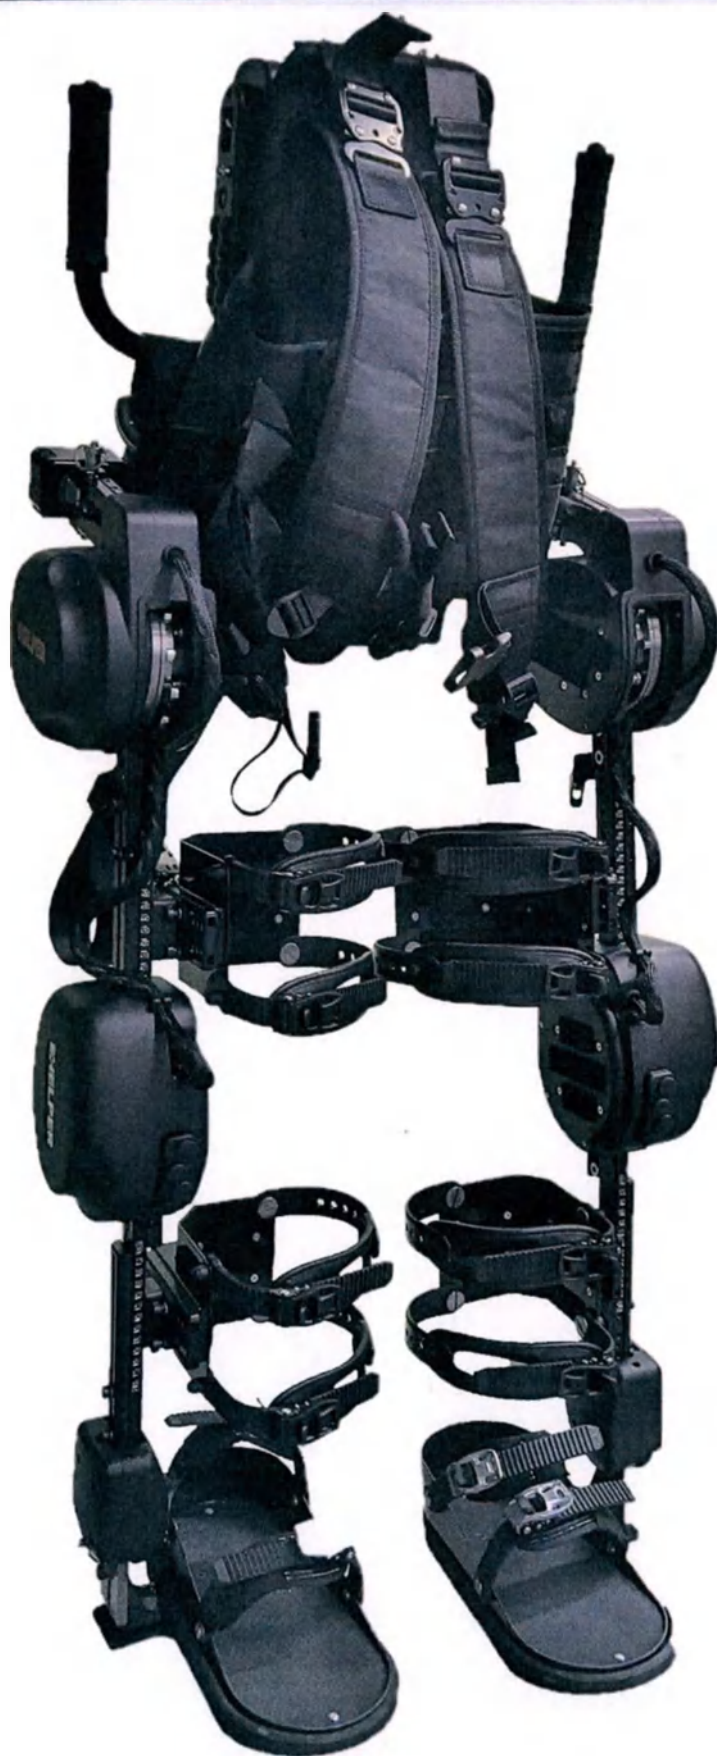

Экзоскелет с ФЭС 8

Опция: ☐ К ☒ С




Режим работы: рабочий цикл 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)
С периодичностью 45 мин / 15 мин (работа / перерыв)

Изделие с внутренним источником питания

Параметры зарядного устройства: — 43.8 В / 1.65 А

IP10

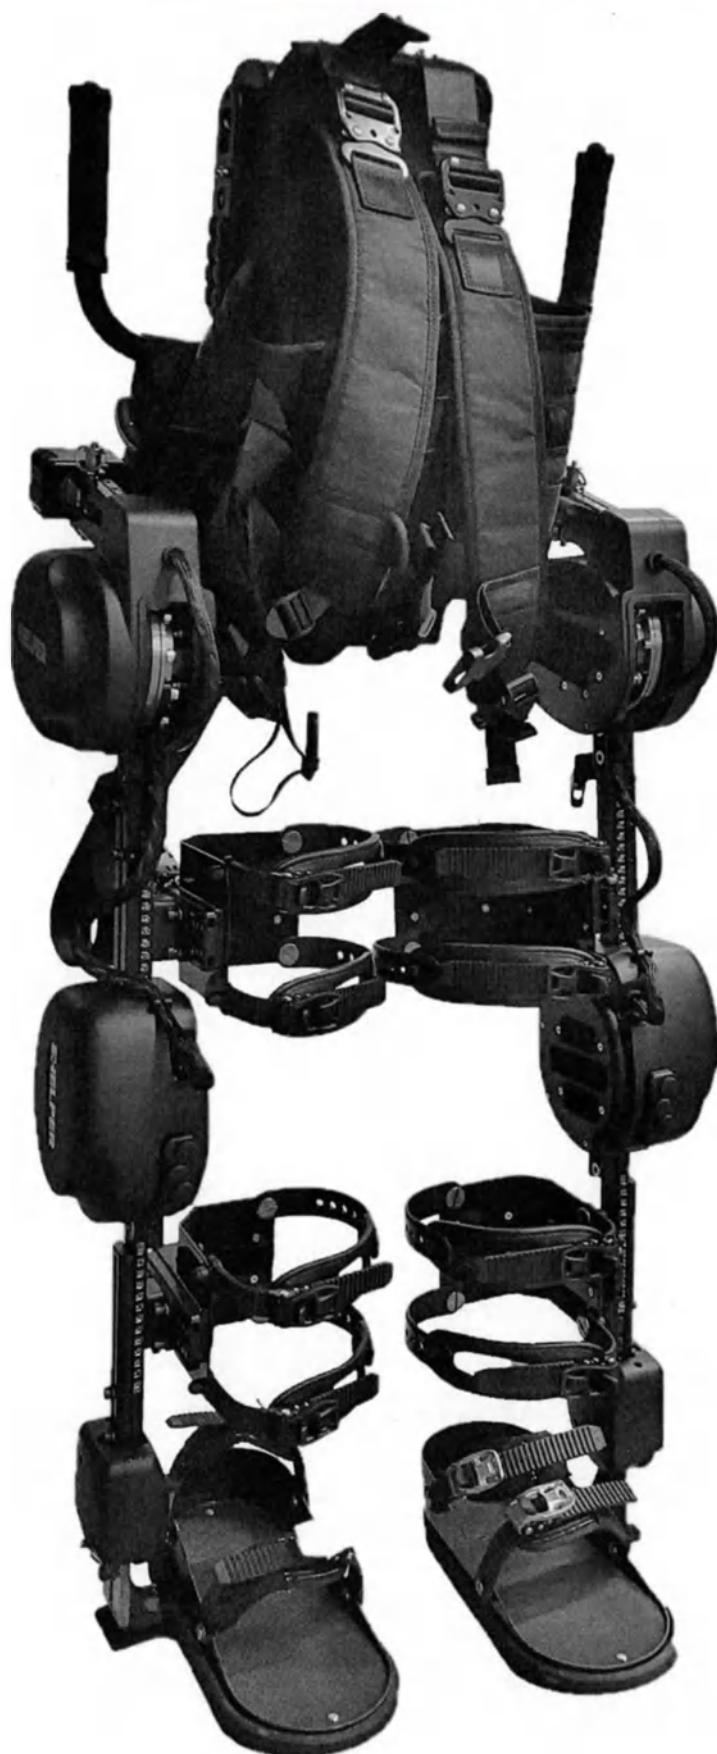

Экзоскелет с ФЭС 16


Опция: ☒ К ☐ С



Режим работы: рабочий цикл 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)
С периодичностью 45 мин / 15 мин (работа / перерыв)

Изделие с внутренним источником питания
Параметры зарядного устройства: — 43.8 В / 1.65 А

IP10

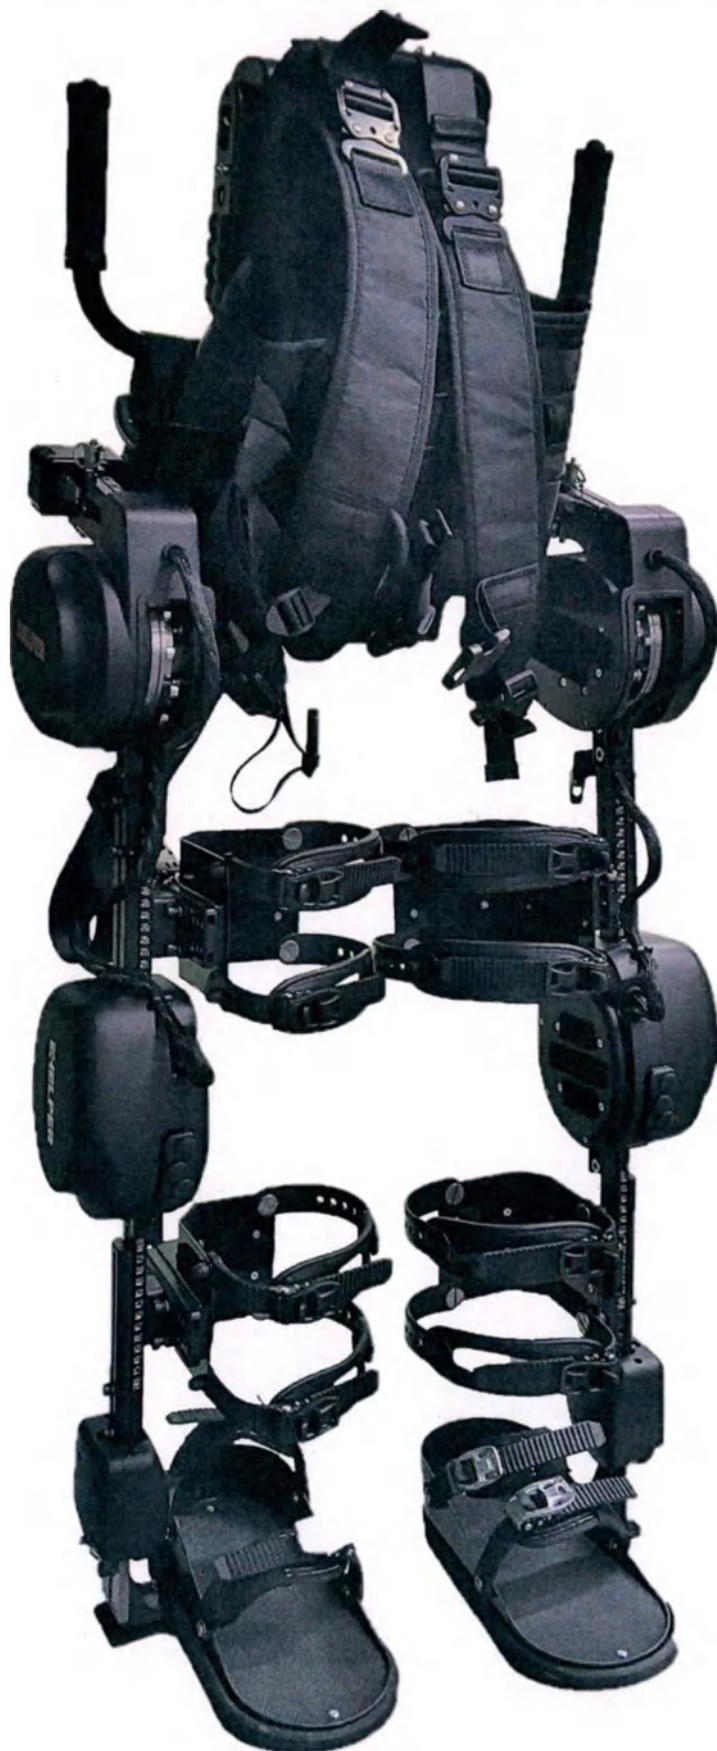

Экзоскелет с ФЭС 16

Опция: ☐ К ☒ С




Режим работы: рабочий цикл 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)
С периодичностью 45 мин / 15 мин (работа / перерыв)

Изделие с внутренним источником питания

Параметры зарядного устройства: — 43.8 В / 1.65 А

IP10

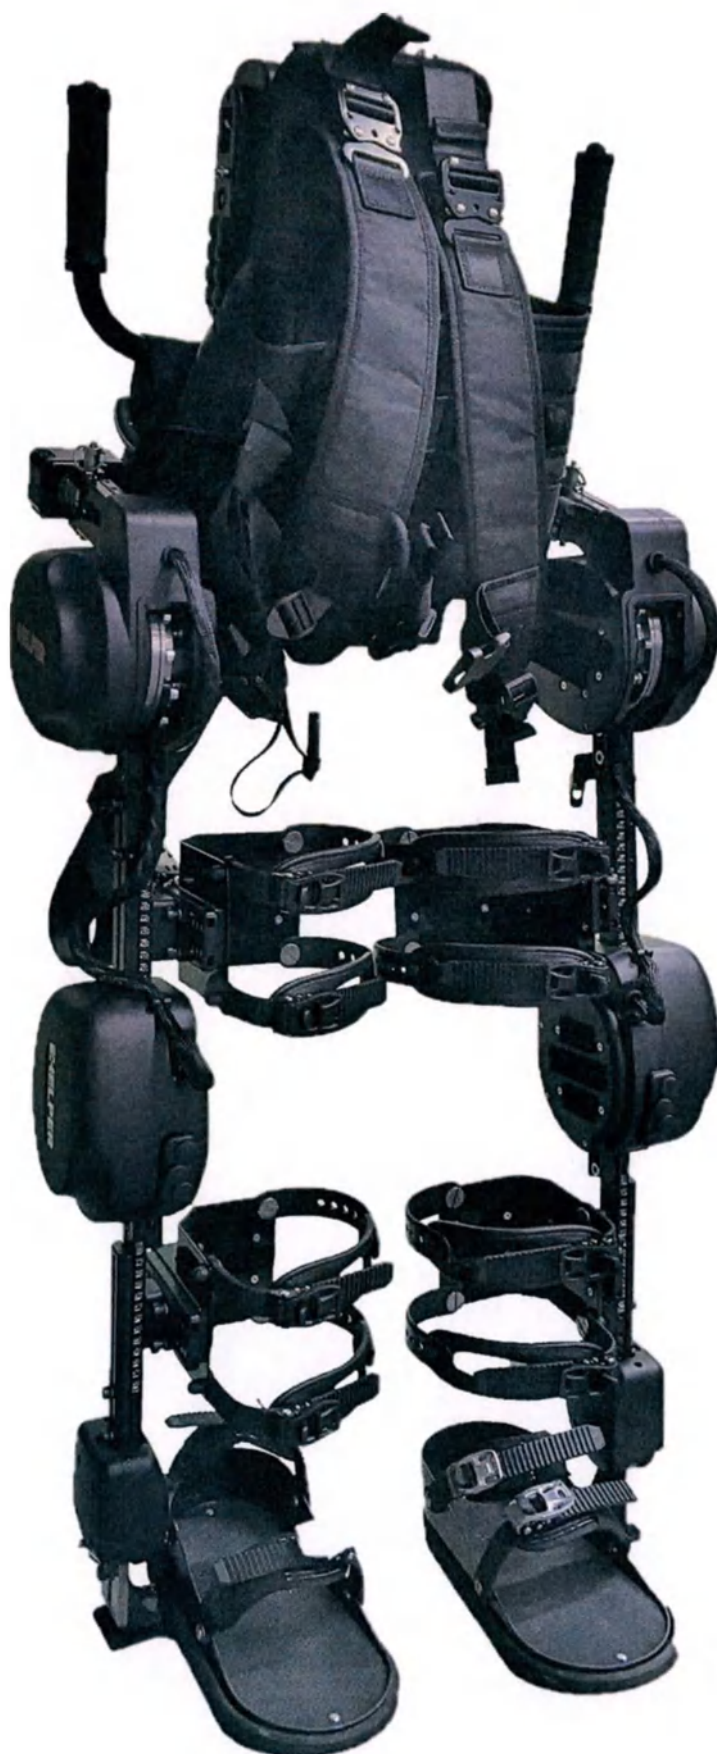

Экзоскелет с ФЭС 16

Опция:



К



С




Режим работы: рабочий цикл 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)
С периодичностью 45 мин / 15 мин (работа / перерыв)

Изделие с внутренним источником питания

Параметры зарядного устройства: — 43.8 В / 1.65 А

IP10

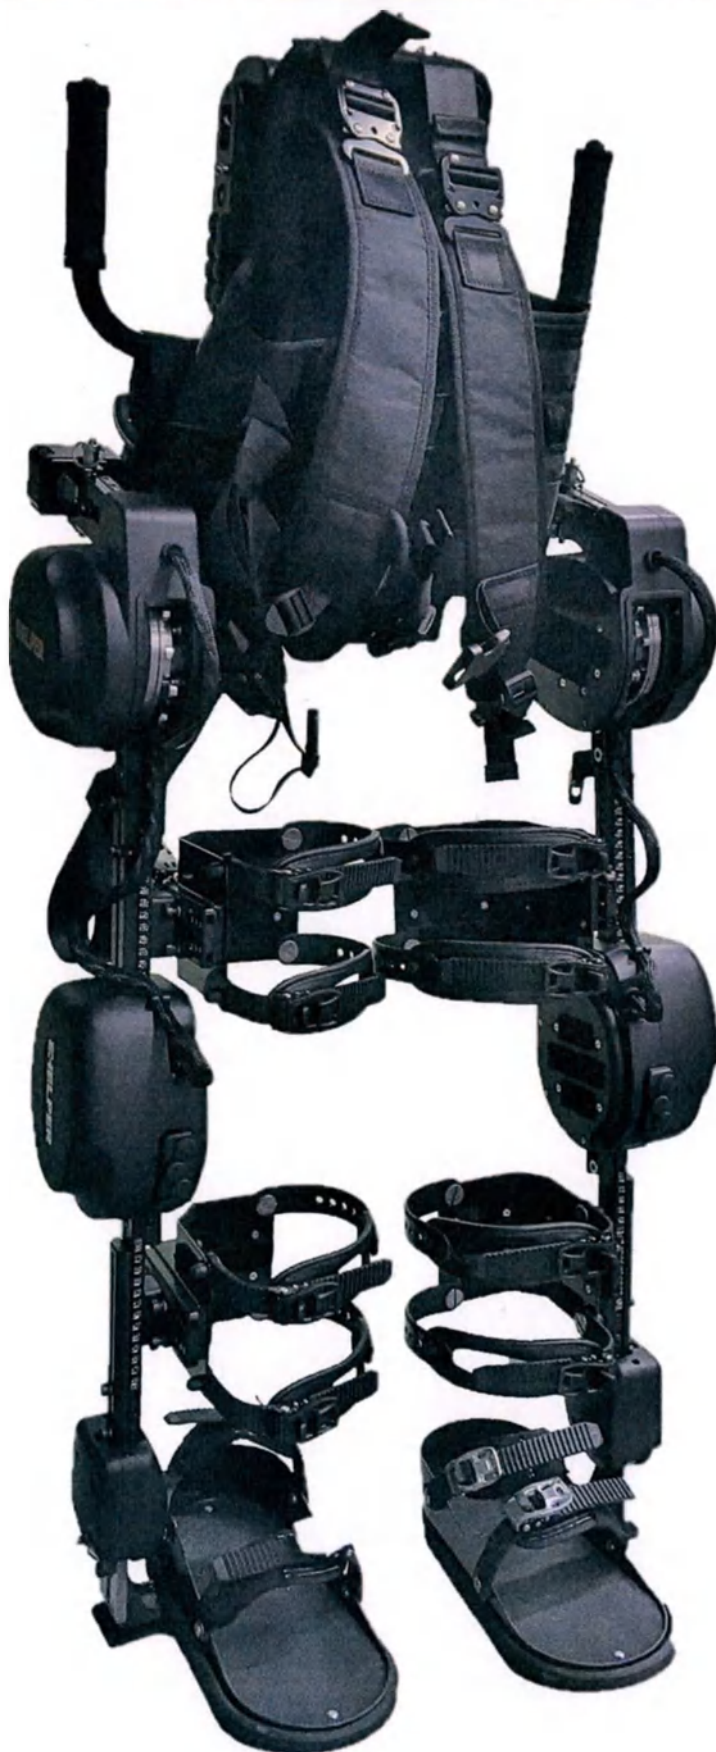



Ручной пульт

Ручной пульт








**Выносная кнопка
для ручного пульта**

Выносная кнопка
для ручного пульта



**Тазовый (седалищный)
ремень**



стирка с вещами,
схожими по цвету



**Подушка для живота
размер 1**



стирка с вещами,
схожими по цвету



**Подушка для живота
размер 2**




стирка с вещами,
схожими по цвету





**Подушка для живота
размер 3**



стирка с вещами,
схожими по цвету

**Подушка для живота
размер 4**



стирка с вещами,
схожими по цвету



Спинальная подушка



стирка с вещами,
схожими по цвету




**Поясничная
подушка**




стирка с вещами,
схожими по цвету




**Сустановка подушка
бедренная**



стирка с вещами,
схожими по цвету



**Суставная подушка
коленная**



стирка с вещами,
схожими по цвету






**Лонгет для ноги
размер 1**



**Подушка лонгета
передняя, размер 1**

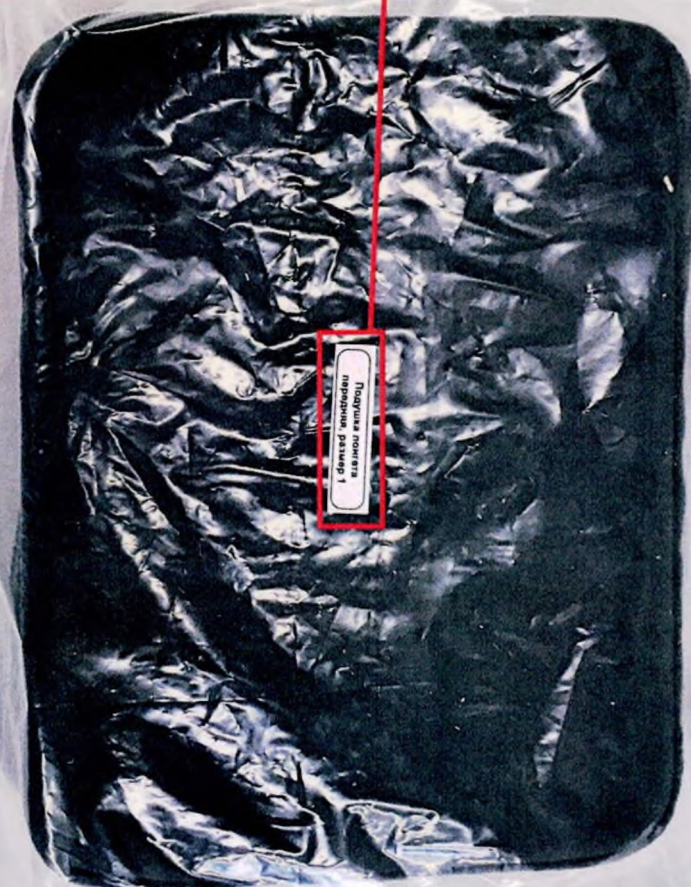

**Подушка лонгета
передняя, размер 2**



**Подушка лонгета
внутренняя, размер 1**



**Подушка лонгета
внутренняя, размер 2**





Беспроводное
устройство управления




 ООО НПФ «Реабилитационные технологии»		
 Зарядное устройство 		
Ном. частота напряжения питания 50 Гц	Ном. напряжение питания 220 В ~	Макс. потребляемая мощность 20 В · А






Кронштейн крепления пульта костыля




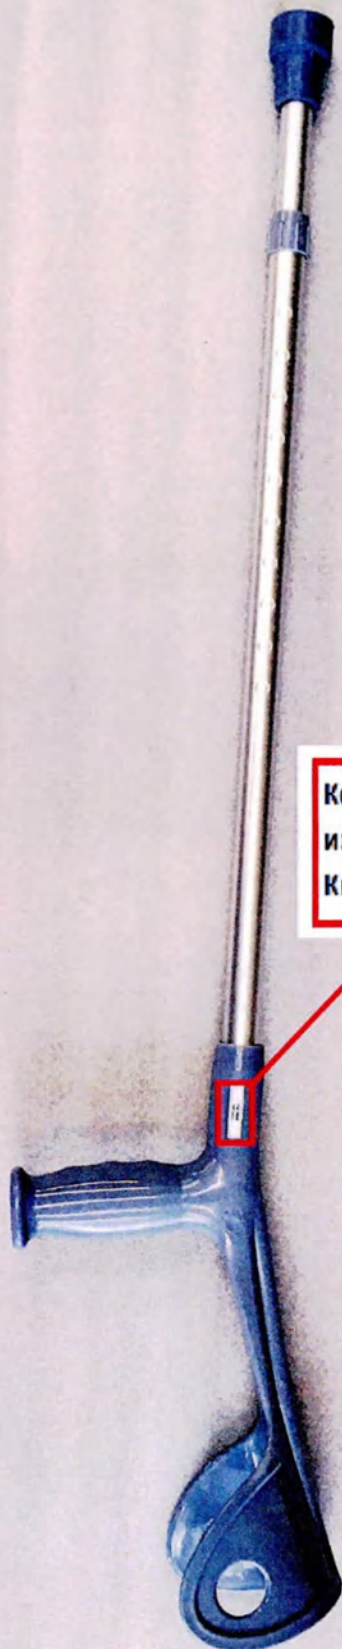

Костыль с опорой под локоть, модель CA851L2,
изготовитель CareMax Rehabilitation Equipment Co.Ltd,
Китай, РУ ФСЗ 2010/08463

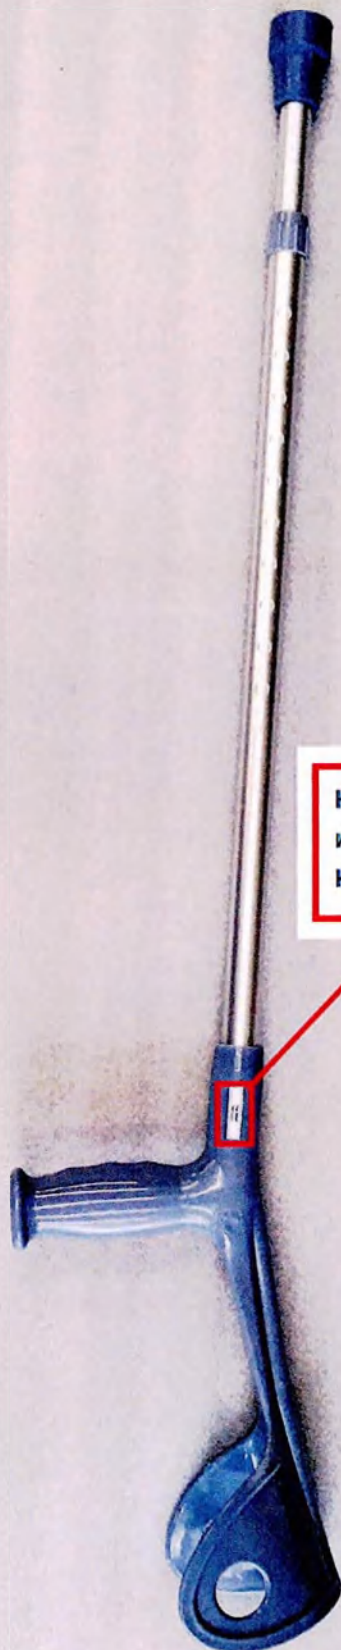

Костыль с опорой под локоть, модель CA851L5,
изготовитель CareMax Rehabilitation Equipment Co.Ltd,
Китай, РУ ФСЗ 2010/08463

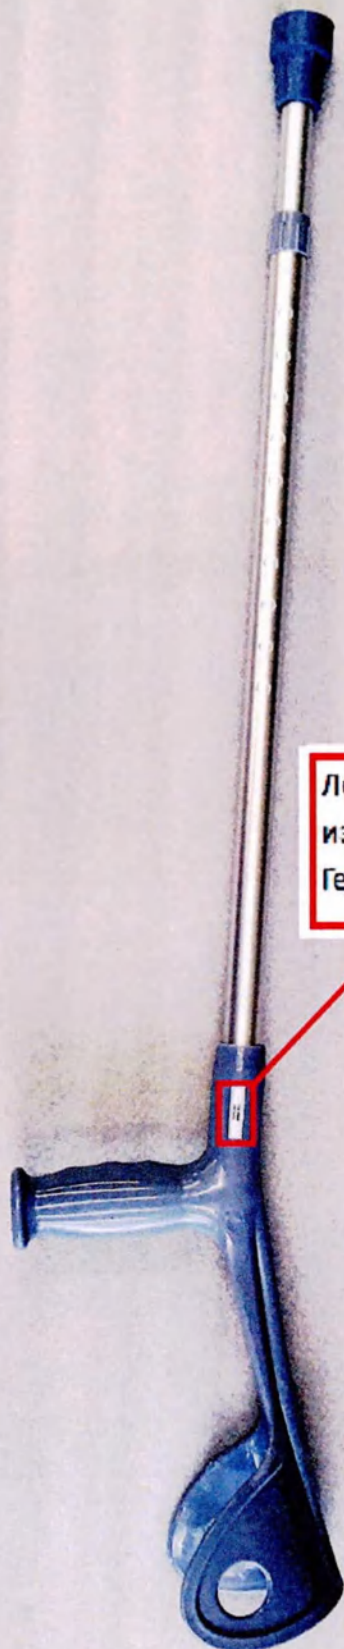

Локтевой костыль Экстраланг, модель 104,
изготовитель REBOTEC Rehabilitationsmittel GmbH,
Германия, РУ ФСЗ 2009/04930


**Отвертка Т-образная
с шестигранными битами
3мм, 4мм, 5мм и 6 мм**

Отвертка Т-образная
с шестигранными битами
3мм, 4мм, 5мм и 6 мм



ИТС-72506 Ключ шестигранный
образный 6мм HEX удлиненный
L=135мм ИТС

Инструмент специально предназначен
для использования в качестве
инструмента для демонтажа
ИТС
Адрес: Тайвань, Тайбэй, Ист Дистрикт, Дунчунгуань, Ян-ань
№146, Dingsong Guang Yuan Road, E. District
Tainping, Taiwan
Экспортёр и поставщик: ООО "АвтоОптТорг", Россия
г. Москва, ул. Наматкина, д. 14, корп. 2, этаж 2
Тел: +7 (495) 212-13-17
Ссылка на подетный обязательный сертификации
Выполнено в Тайване
Срок годности не ограничен

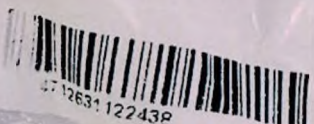

Ключ шестигранный 6 мм

Ключ шестигранный 6 мм



**Клин
лордоза**

**Клин лордоза
увеличенный**



Кабель ФЭС
тип БН размер 1



Кабель ФЭС
тип БН размер 2



Кабель ФЭС
тип КР размер 1

Кабель ФЭС
тип КР размер 2



Кабель ФЭС
тип КН размер 1



Кабель ФЭС
тип КН размер 2




Кабель ФЭС
тип КН-3 размер 1



Кабель ФЭС
тип КН-3 размер 2



Лента фиксирующая
для электродов размер 2



стирка с вещами,
схожими по цвету

Электрод ЭКГ Электрод ЭКГ Электрод ЭКГ Электрод ЭКГ Электрод ЭКГ Электрод ЭКГ **УОМЗ** 30 штук Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ») **Электрод ЭКГ одноразовый ЭКО**

ЭЛЕКТРОД ЭКГ С ГЕЛЕМ Ag/AgCl;
 PREGELLED ECG ELECTRODES Ag/AgCl;
 ELECTRODES ECG PREGELIFIEES Ag/AgCl;
 VORGELIERTE ECG ELEKTRODEN Ag/AgCl;
 ELECTRODOS ECG Ag/AgCl;
 ELETTRODI ECG PREGELLATI IN Ag/AgCl;

ELECTRODOS DE ECG Ag/AgCl COM GEL;
 PREGELLED ECG ELECTRODEN Ag/AgCl;
 PRÆFYLDETE EKG ELEKTRODER Ag/AgCl;
 FÖRGELADE EKG ELEKTRODER Ag/AgCl;
 ESITÄYTETTYJÄ EKG-ELEKTRODEJA Ag/AgCl;
 КАРДИОЛОГИКА НАЛЕКТРОДИ НАГ Ag/AgCl ME ZELE.

ТУ 9441-096-07539541-2007
 № ФСР 2008/01666 от 07.02.2019
 http://www.uomz.com
 e-mail: kancelyariya@uomz.com
 тел.: +7(343)229-83-84
 ул. Восточная, 33 б. 620100, г. Екатеринбург, Россия



3220.00000000

ЭЛЕКТРОДА	26	30	40	50	26	30	40	50
LOT	01 01 2025							
№	01230283							

Электрод ЭКГ
Электрод ЭКГ
Электрод ЭКГ
Электрод ЭКГ
Электрод ЭКГ

УОМЗ
 Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени З.Я. Яковлева (АО ПО УОМЗ)»

Электрод ЭКГ одноразовый ЭКО 30 шт.

ЭЛЕКТРОД ЭКГ С ГЕЛЕМ Ag/AgCl;
 PREGELLED ECG ELECTRODES Ag/AgCl;
 ELECTRODES ECG PREGELIFIEES Ag/AgCl;
 VORGELIERTE ECG ELEKTRODEN Ag/AgCl;
 ELECTRODOS DE ECG Ag/AgCl;
 ELECTRODOS DE ECG ELECTRODEN Ag/AgCl;
 PREGELLED ECG ELECTRODEN Ag/AgCl;
 PRÆFYLDT ECG ELEKTRODER Ag/AgCl;
 FÖRGELADE EKG ELEKTRODER Ag/AgCl;
 ESITÄYTETTYJÄ EKG-ELEKTRODEJA Ag/AgCl;
 KARDIOLOGIKA HÄKTRODIA HKT Ag/AgCl ME ZELE.

№ ФСР 2008/01666 от 07.02.2019
<http://www.uomz.com>
 e-mail: kanceliya@uomz.com
 тел.: +7(343)229-83-84
 ул. Восточная, 33 б. 620100, г. Екатеринбург, Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 1 НЕДЕЛЯ

Max 26°C
 Min 12°C

3220.00000000 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07

ЭЛЕКТРОДА	26	30	✓ 50	26	30	40	50
-----------	----	----	------	----	----	----	----

31.01.2025

LOT 01230283

УОМЗ **Электрод ЭКГ** **ЭКО** **30** штук

Актционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени З.А. Яковлева» (АО «ПО «УОМЗ»)

Электрод ЭКГ одноразовый ЭКО

ЭЛЕКТРОД ЭКГ С ГЕЛЕМ Ag/AgCl;
 PREGELLED ECG ELECTRODES Ag/AgCl;
 ELECTRODES ECG PREGELIFIEES Ag/AgCl;
 VORGELEIETER EKG ELEKTRODEN Ag/AgCl;
 ELECTRODOS ECG ELEKTRODEN Ag/AgCl;
 ELETTRODI ECG PREGELLATI IN Ag/AgCl;

ELECTRODOS DE ECG Ag/AgCl COM GEL;
 PREGELLED ECG ELECTRODEN Ag/AgCl;
 PRÆFYLDE EKG ELEKTRODER Ag/AgCl;
 FÖRGLADE EKG ELEKTRODEJA Ag/AgCl;
 ESITÄYTETTYJÄ EKG-ELEKTRODEJA Ag/AgCl;
 КАРДИОЛОГИКА НАЕКТРОДИ НАГ Ag/AgCl ME ZELE.

TV 9441-096-07539541-2007
 № ФСР 2008/01666 от 07.02.2019
 http://www.uomz.com
 e-mail: kancelyariya@uomz.com
 тел. +7(343)229-83-84
 ул. Восточная, 33 б, 620100, г. Екатеринбург, Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
 1 НЕДЕЛЯ

3220.00000000 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07

ЭЛЕКТРОДА	26	30	40	50	26	30	40	50
-----------	----	----	----	----	----	----	----	----

LOT 01230285

№ 31 11 2025



ЭЛЕКТРОТОНУС

Электрод физиотерапевтический с токопроводящей углеродной тканью

не стерильно

LOT 347




10/2022

Гарантийный срок хранения – 2 года со
дня изготовления при хранении в закрытых
помещениях при температуре от –50 до +
40°C и влажности 98% (при 25°C).



ООО «МТЦ «Электротонус»
400105, г. Волгоград, ул. Хользунова, д. 18/1,
<http://elektrotonus.ru>; info@elektrotonus.ru
тел.: (8442) 50-20-16, факс: (8442) 28-80-33.

ТУ 9398-001-64660538-2014
ПУ № РЗН 2015/3490 от 31.12.2015г.



ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ
КАРТА
04/2023

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА
ПРОТЕЗИРУЮЩЕГОСЯ
ПРОТЕЗ ДИАМЕТР 32 мм.

СВОБОДНЫЙ КОНТАКТ
Для индивидуального использования
Код: 00000000000000000000

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА
ПРОТЕЗИРУЮЩЕГОСЯ
ПРОТЕЗ ДИАМЕТР 32 мм.
СВОБОДНЫЙ КОНТАКТ
Для индивидуального использования
Код: 00000000000000000000



ЭЛЕКТРОТОНУС

REF CN5050S

02/2023



**Электрод адгезивный самоклеящийся
для низкочастотной электротерапии
квадратный 50x50 мм.**

кнопочный контакт

Для индивидуального пользования

Количество в упаковке: 4 шт.

Срок эксплуатации электродов – не более 30 циклов.
Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

ООО «МТЦ «Электротонус»
400105, г. Волгоград, ул. Хользунова, д. 18/1;
<http://elektrotonus.ru>; info@elektrotonus.ru
тел.: (8442) 50-20-16, факс: (8442) 28-80-33.

ТУ 26.60.13-001-64660538-2018

ПУ № РЗН 2019/9021 от 07.10.2019г.

Декларация о соответствии № РОСС RU.Д-РУ.ИМ18.В.00371/19

Срок действия: 12.11.2019г. – 11.11.2022г.

тел.: (8442) 50-20-16, факс: (8442) 28-80-33

ТУ 26.60.13-001-64660538-2018

ПУ № РЗН 2019/9021 от 07.10.2019г.

Декларация о соответствии № РОСС RU.Д-РУ.ИМ18.В.00371/19

Срок действия: 12.11.2019г. – 11.11.2022г.



ЭЛЕКТРОТОНУС

REF CN50100S

LOT B200105

04/2023



Срок эксплуатации электродов – не более 30 циклов.
Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.



ООО «МТЦ «Электротонус»
400105, г. Волгоград, ул. Хользунова, д. 18/1;
<http://elektrotonus.ru>; info@elektrotonus.ru
тел.: (8442) 50-20-16, факс: (8442) 28-80-33.

ТУ 26.60.13-001-64660538-2018

Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/9021 от 07.10.2019г.

**Электрод адгезивный самоклеящийся
для низкочастотной электротерапии
прямоугольный 50x100 мм.**

кнопочный контакт

Для индивидуального пользования

Количество в упаковке: 4 шт.



Упаковщик № 4		Кол-во
Наименование	Размер	
Прямоугольный	Ø 50	32
Глазной		
Полумаска Бергонье		
Ушной		
Воротниковый		
Горловой		



Упаковщик №4		
Наименование	Размер	Кол-во
Прямоугольный	40x50	16
Глазной		
Полумаска Бергонье		
Ушной		
Воротниковый		
Горловой		


Упаковщик №	
Наименование	Размер
Прямоугольный	30 x 60
Глазной	
Полумаска Бергонье	
Ушной	
Воротниковый	
Горловой	

Упаковщик №		
Наименование	Размер	Кол-во
Прямоугольный	40 x 100	2
Глазной		
Полумаска Бергонье		
Ушной		
Воротниковый		
Горловой		

Упаковщик №		
Наименование	Размер	Кол-во
Прямоугольный	50 x 100	2
Глазной		
Полумаска Бергонье		
Ушной		
Воротниковый		
Горловой		

Все заживёт.[®]

СДЕЛАНО В РОССИИ

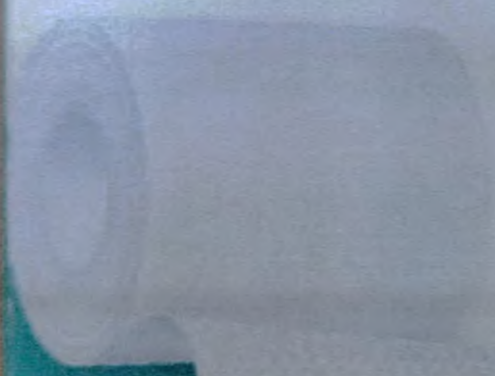

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
ФИКСИРУЮЩИЙ
для фиксации предметов и
материалов медицинского
назначения

Ролепласт

на нетканой основе

10 см x 10 м
1 штука



Способ применения: 1. Извлечь из упаковки. 2. Отрезать с помощью ножниц кусок нужного размера. 3. Снять защитный слой. 4. Зафиксировать лейкопластырем предметы или материалы медицинского назначения.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов/материалов изделия.

Лейкопластырь фиксирующий, нестерильный «Ролепласт» по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020

Регистрационное удостоверение РУ ФСР 2007/00789 от 28.10.2020

Условия хранения: 2(С) ГОСТ 15150-69 (при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98%)

Условия транспортирования: по условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69

Утилизация: в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 для класса А опасности.

10 см x 10 м

1 штука



4 607021 270625



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

фиксирующий, нестерильный, «Ролепласт»

по ТУ 21.20.24-004-74639918-2020;

РУ № ФСР 2007/00789 от 05.07.2021г.

Вид подложки	нетканая основа
Размер	15см x 10м
Количество	1шт.
Дата изготовления	02 05 22
Серия №	020522M3
Использовать до	05 2025

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначен для фиксации предметов и материалов медицинского назначения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Извлечь из упаковки, отрезать с помощью ножниц кусок нужного размера, снять защитный слой, зафиксировать предметы или материалы медицинского назначения.

СОСТАВ: полотно перфорированное нетканое, прерывистый клеевой слой, бумага антиадгезионная

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов/материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ: в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 для класса А опасности

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 2(С) ГОСТ 15150-69. (при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98%)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ: по условиям хранения 5 (С.84) ГОСТ 15150-69

Беречь изделие от влаги и прямых солнечных лучей. Не применять повторно.


Произведено для ООО «БИОТЕКФАРМ»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Перевязочные Материалы» Россия, 141351, Московская обл.

Сергиево-Посадский г. о, д. Жучки, д.2н. Тел: +7(495)984-58-79

Отдел продаж: тел: +7(495)780-92-36

«Все заживет»®









**Жидкость электродная
контактная высокопроводящая
для ЭКГ и других
электрофизиологических исследований
«Униспрей»**

Жидкость электродная высокопроводящая контактная для ЭКГ, дефибрилляции, электрокардиоскопирования, электромиостимуляции.
Применение: наносится на электрод или тело пациента для обеспечения контакта с кожей. После окончания процедуры жидкость снимается салфеткой и смывается водой.

«Униспрей» не вызывает аллергии.

Состав: вода, глицерин, хлорид калия, пропанглиол, поливинилпирролидон, консервант, хлорид калия, дисодиум ЭДТА, краситель.
Производитель: ООО «Гельтек-Медика», Россия, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 1, стр. 1, тел.: +7(495) 956-93-66.

Серийный № E4422

код:

310

Дата изг.: 10.22

годен до:

10.23

Исх. № 76003983-2005. Рег. уд. № 010.08253 от 15.12.2005
Хранить при температуре от +5°C до +40°C
Срок годности по классу А (СанПиН 2.1.7.230-10)


**Ремень
для подвеса**







**Сиденье
с ящиком**

**Крепление
для беспроводного
устройства управления**

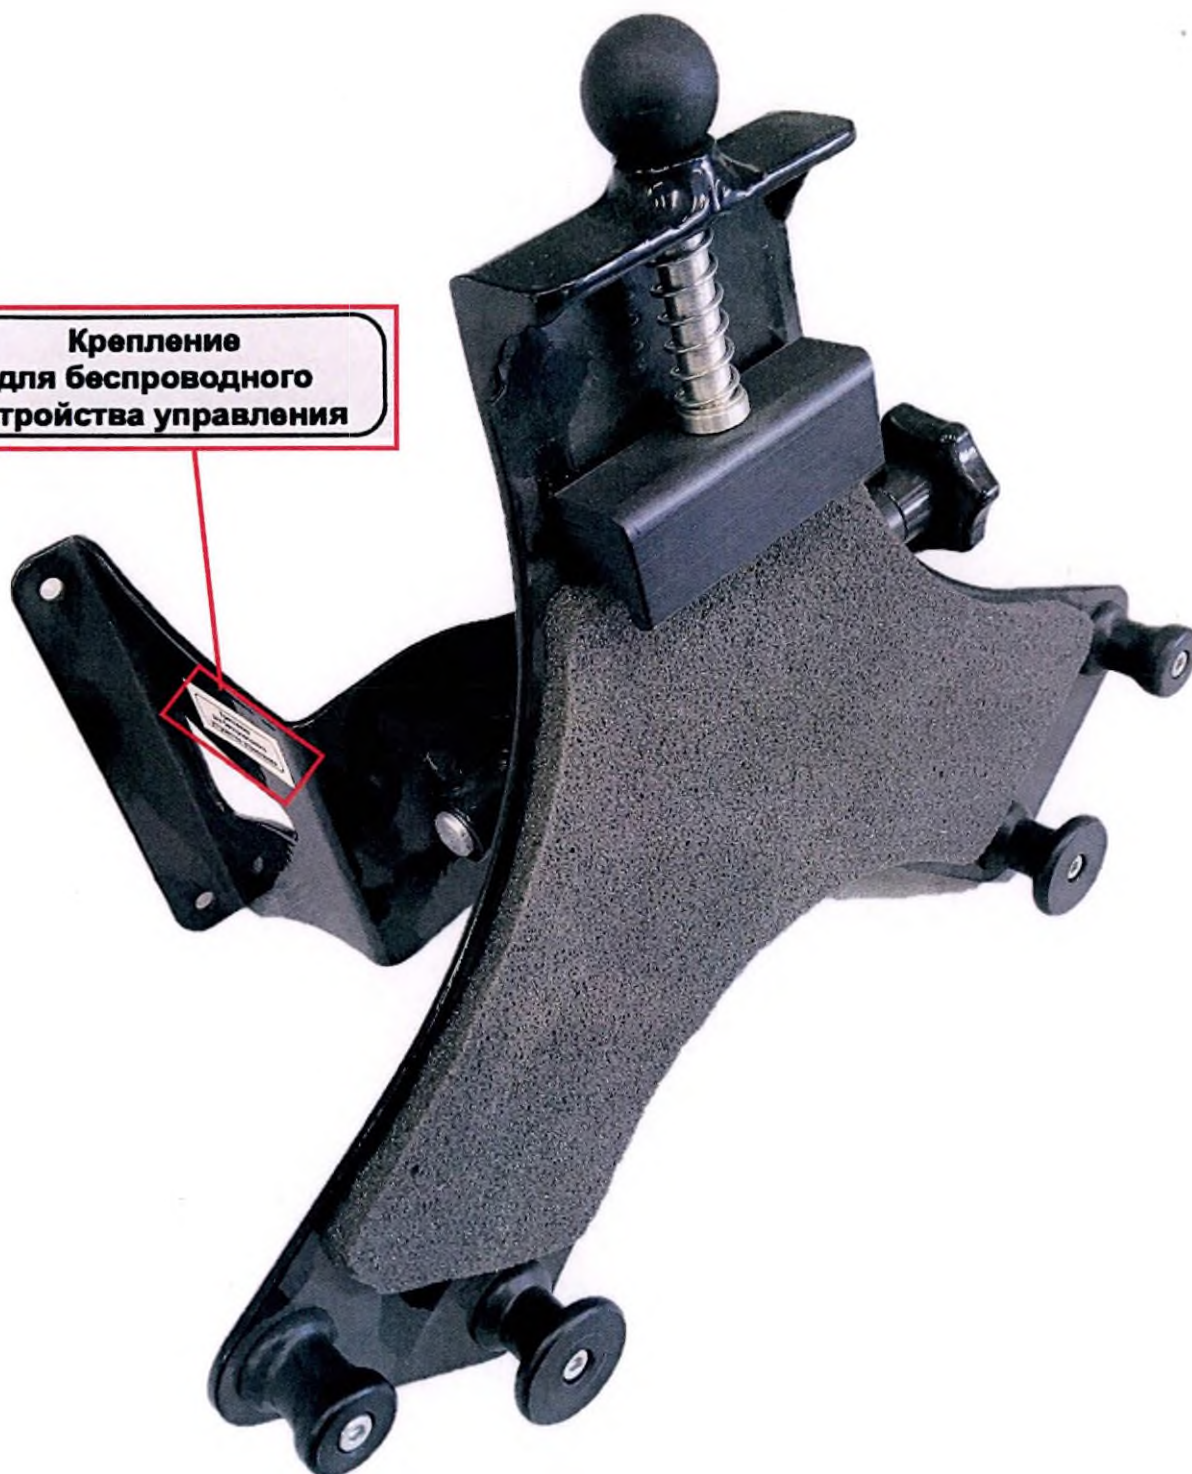

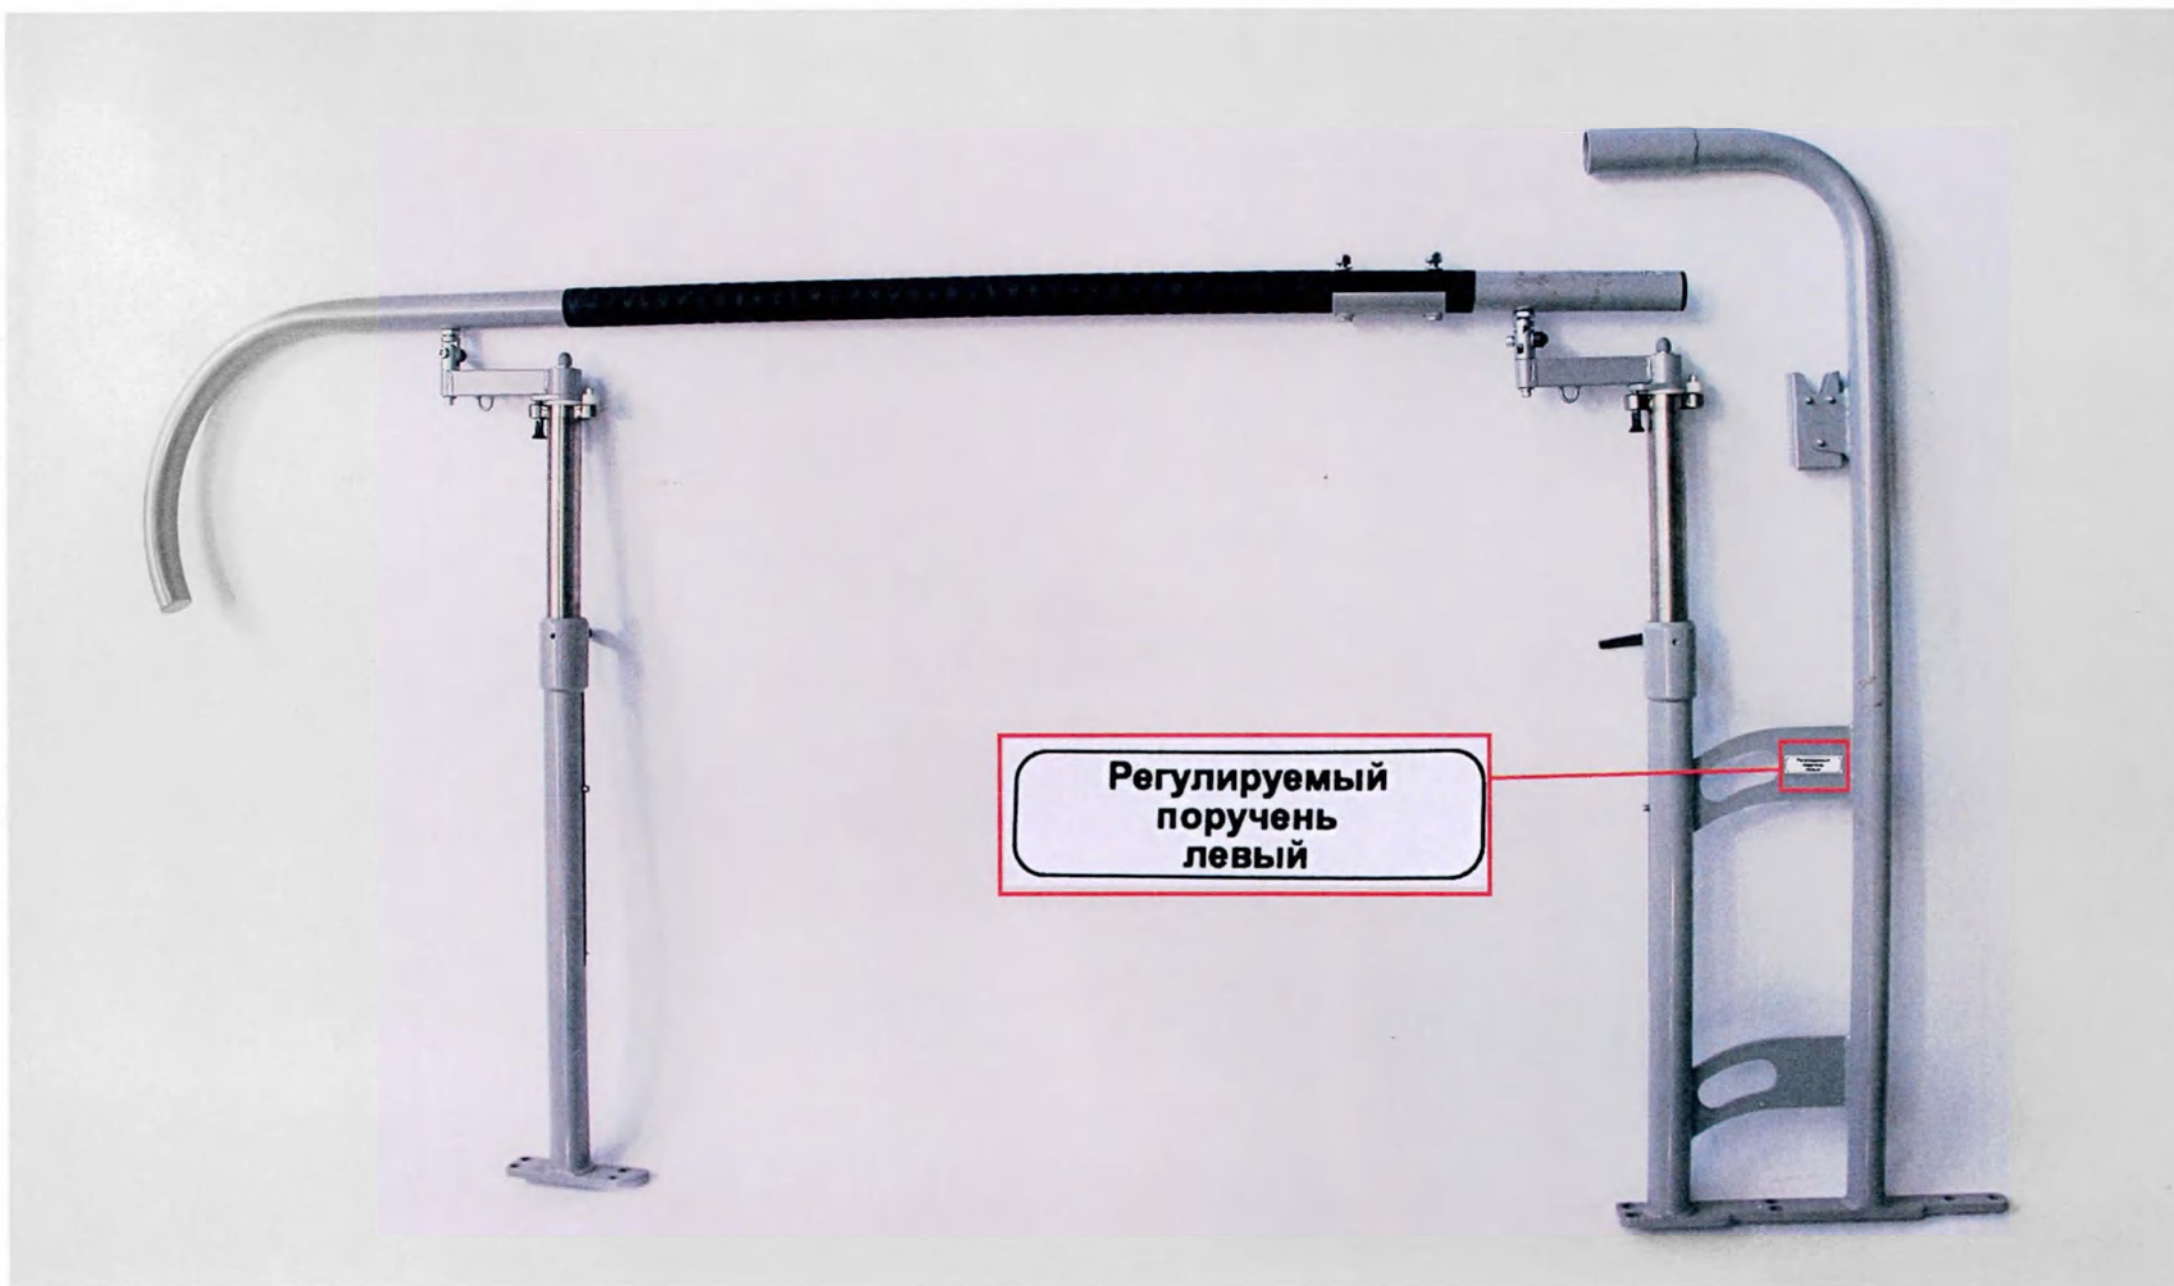

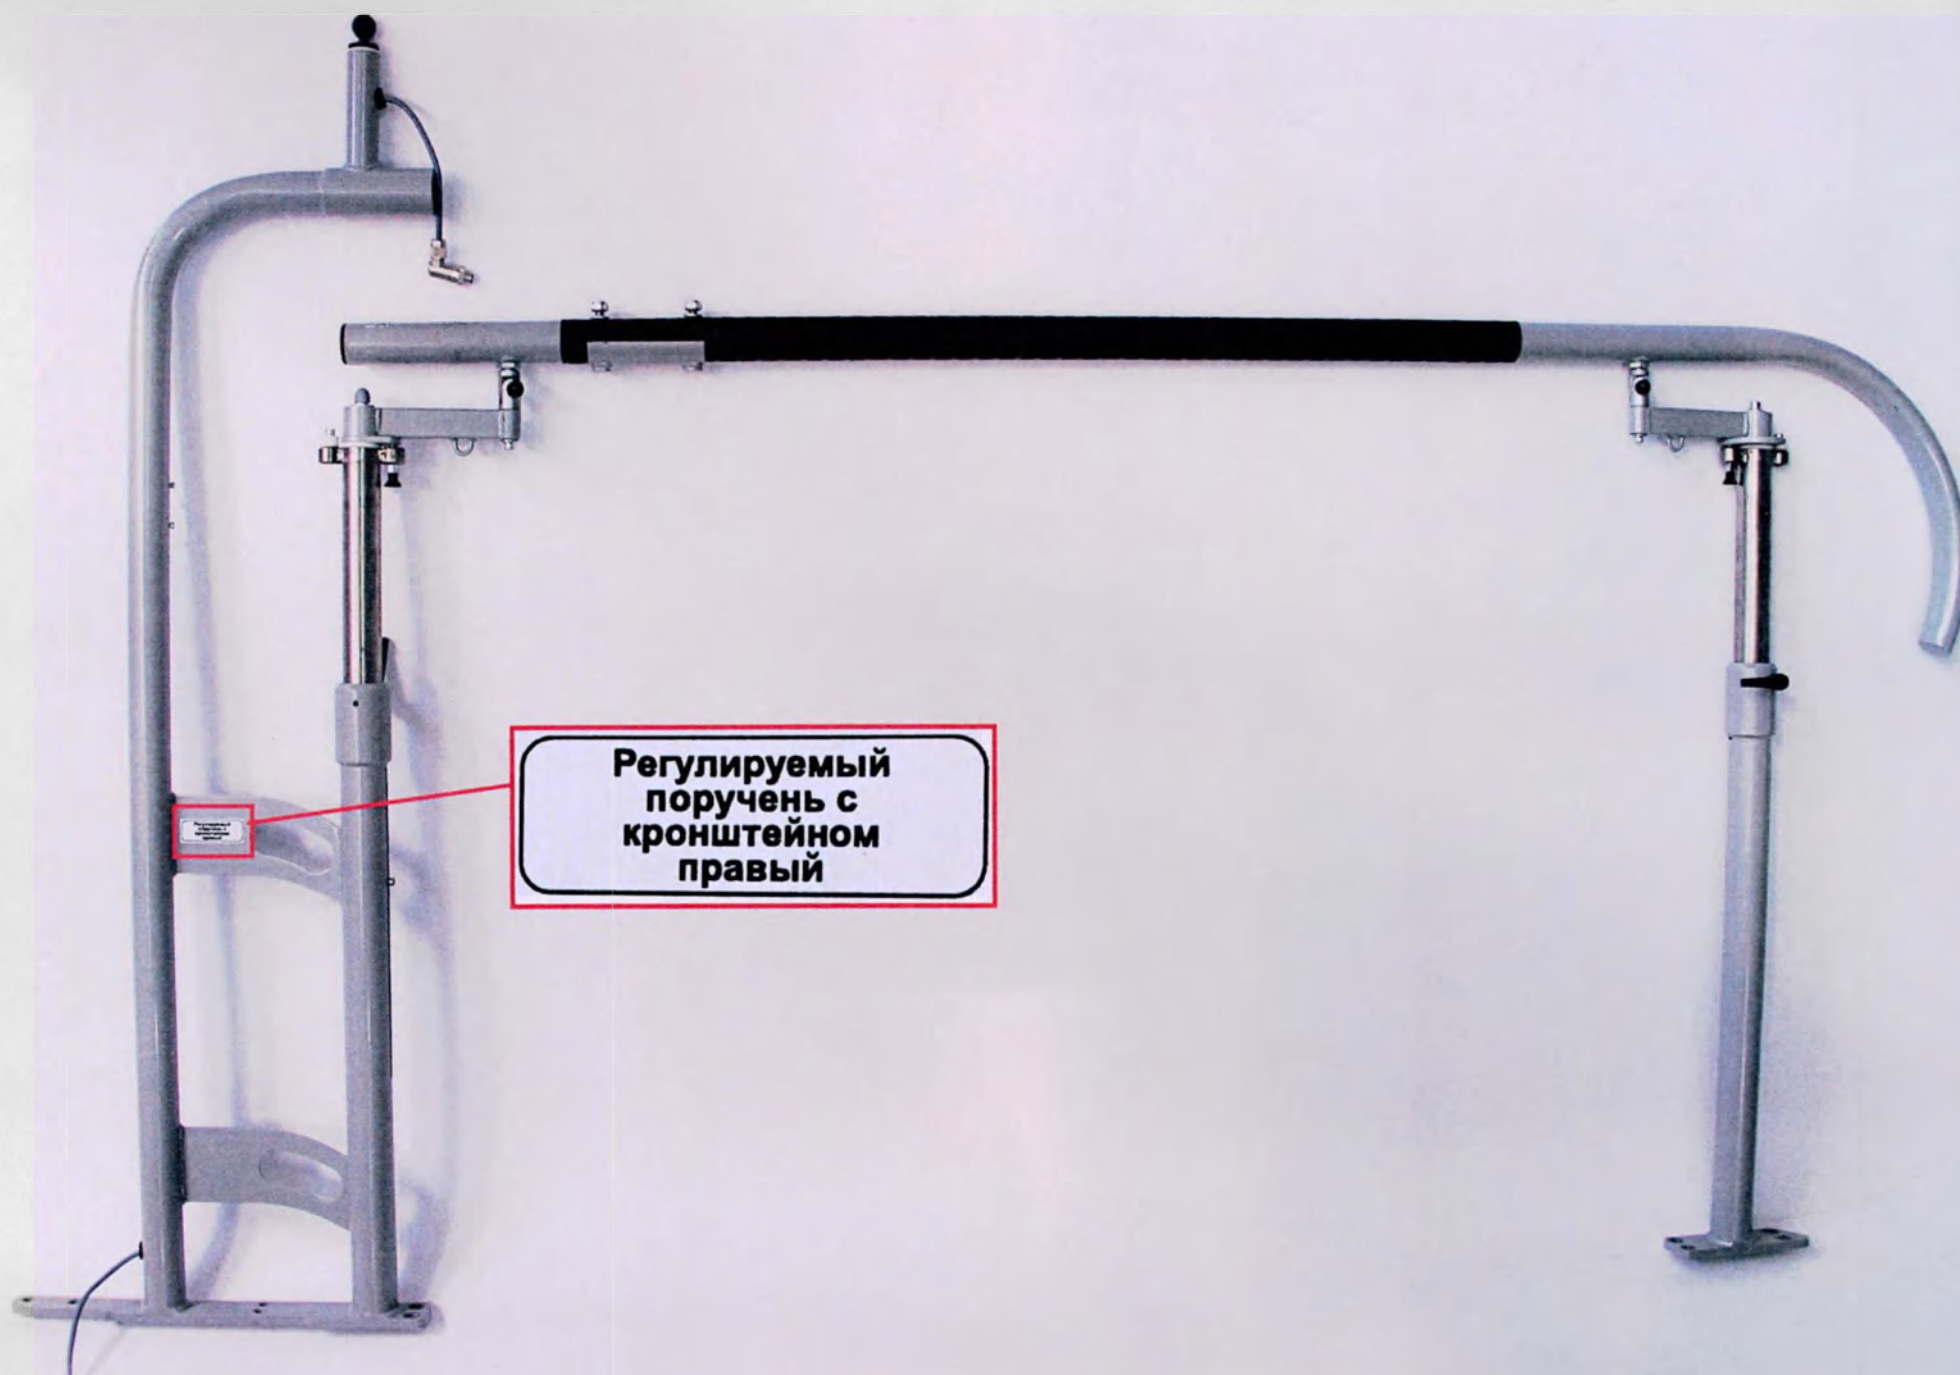


**Регулируемый
поручень с
кронштейном
правый**





**Передняя дуга
безопасности для
регулируемых
поручней**


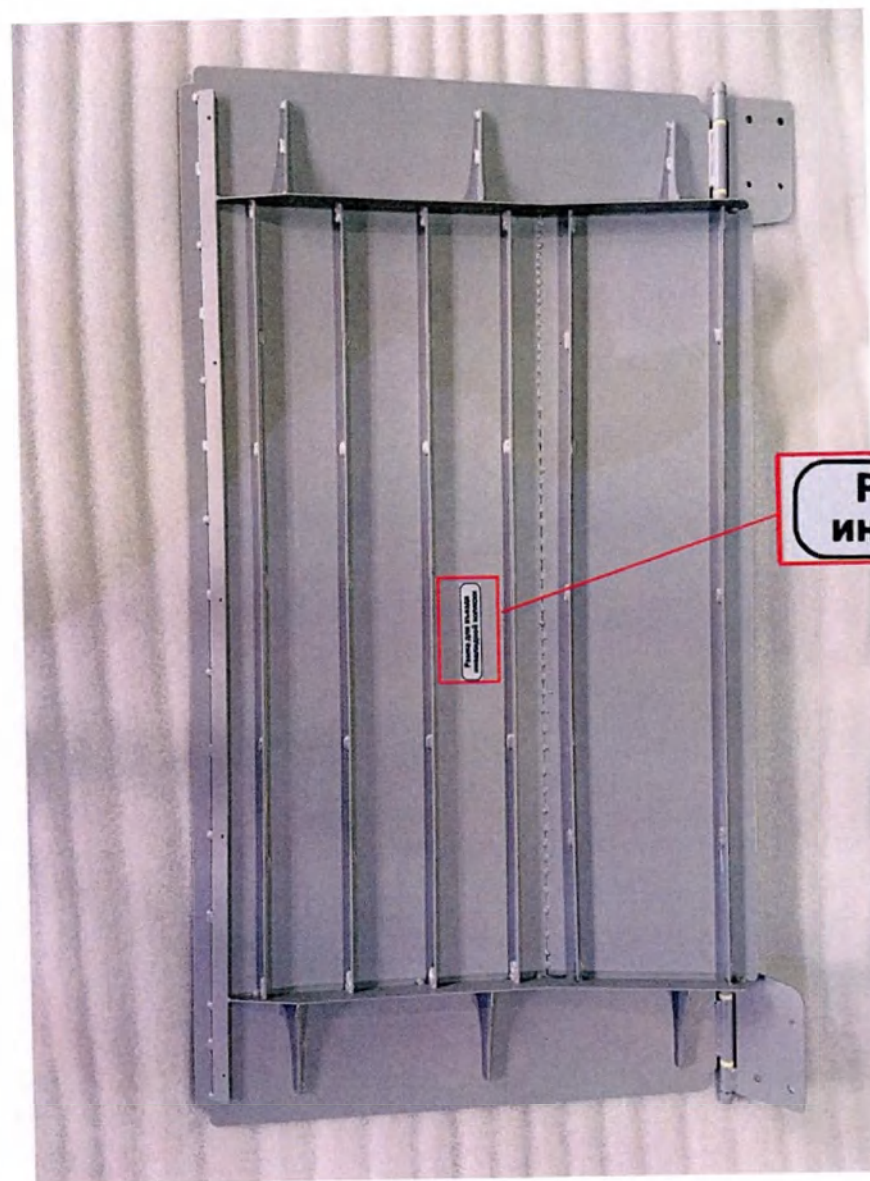


**Рампа для въезда
инвалидной коляски**

**Сиденье для
медицинского
персонала**





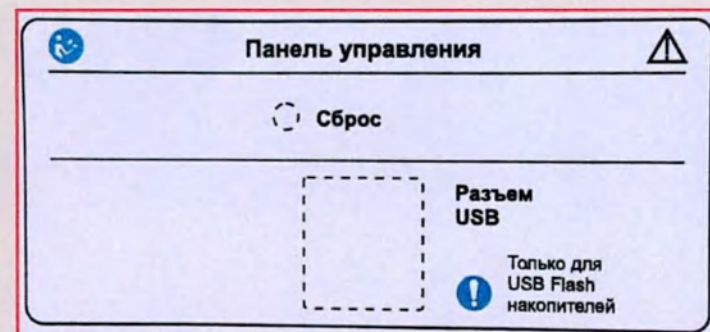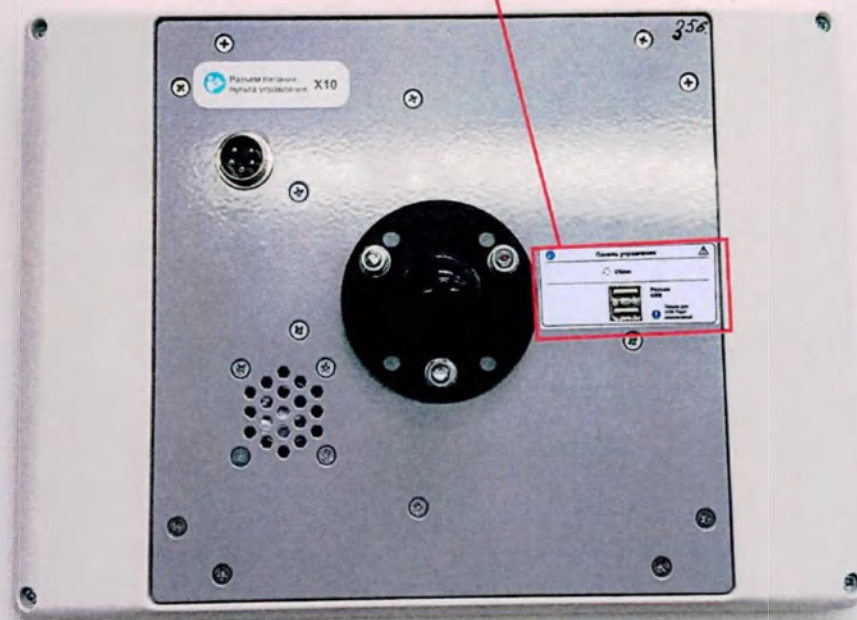





Трансформатор разделительный




При работе необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям


ОСТОРОЖНО! ВЫСОКОЕ НАПЯЖЕНИЕ!
ВНИМАНИЕ! При работе необходимо обеспечить свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям.
Технические характеристики:
Напряжение питания: 220 В
Мощность: 1000 Вт
Сила тока: 4,5 А
Степень защиты: IP20
Срок службы: не менее 10 лет
Гарантия: 1 год


ОСТОРОЖНО! ВЫСОКОЕ НАПЯЖЕНИЕ!
X1
ПОРЯДОК РАБОТЫ:
1. Проверка исправности оборудования.
2. Проверка наличия напряжения.
3. Проверка отсутствия напряжения.
4. Проверка отсутствия напряжения.
5. Проверка отсутствия напряжения.

Кабель питания беговой дорожки

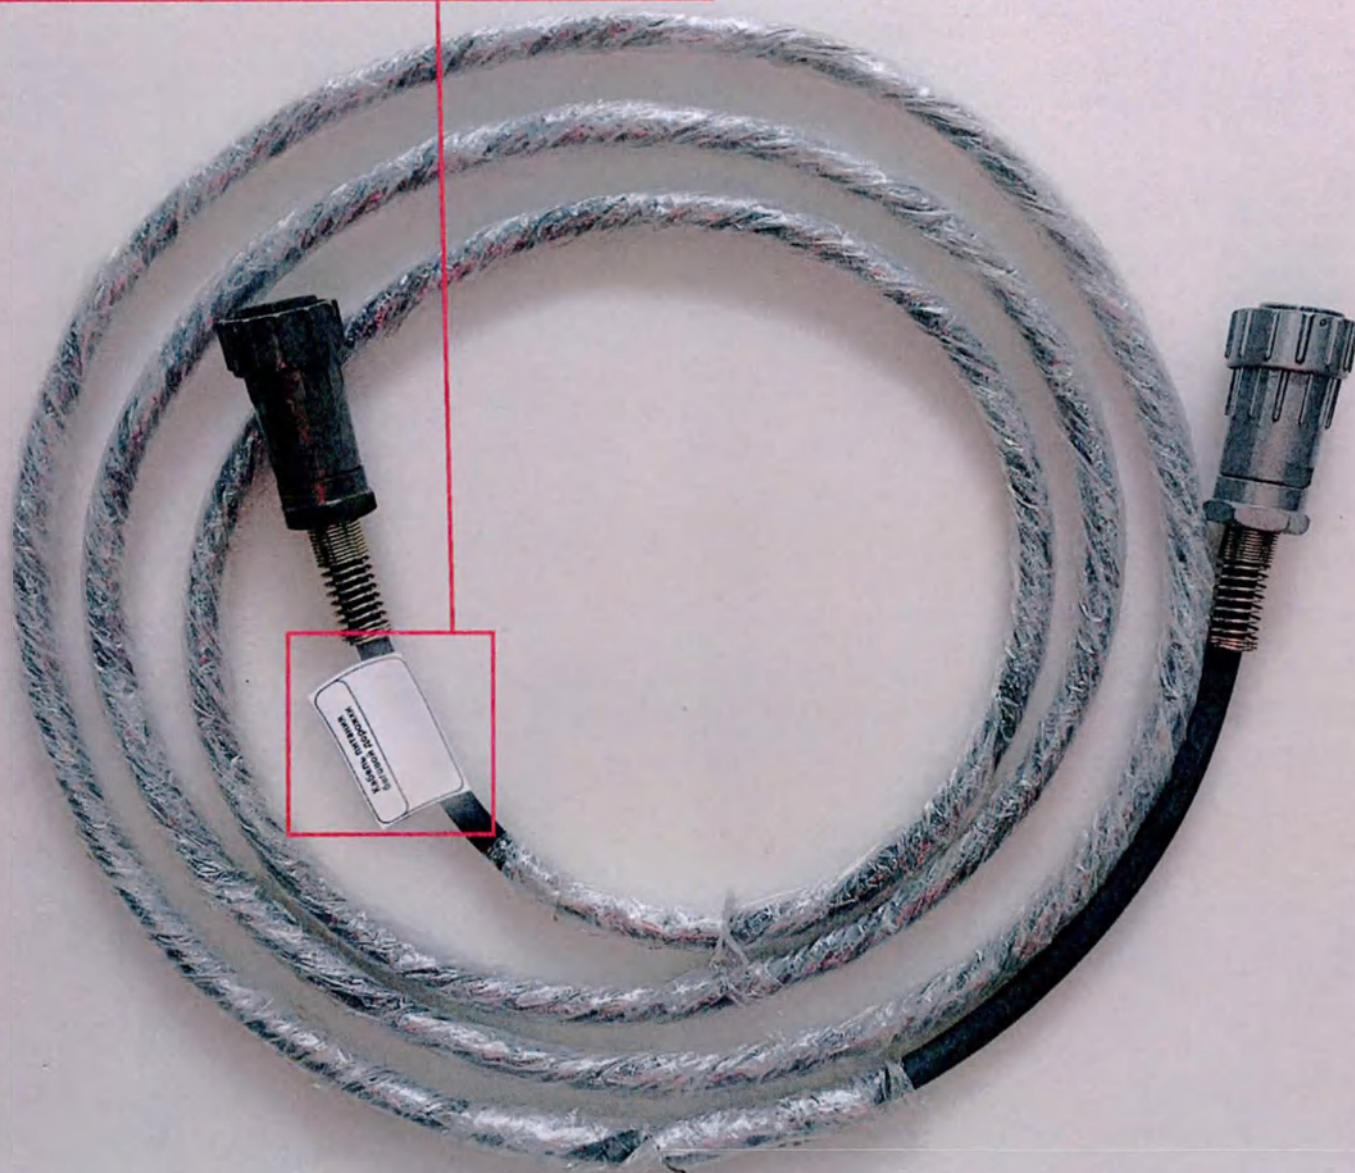

Кабель сетевой

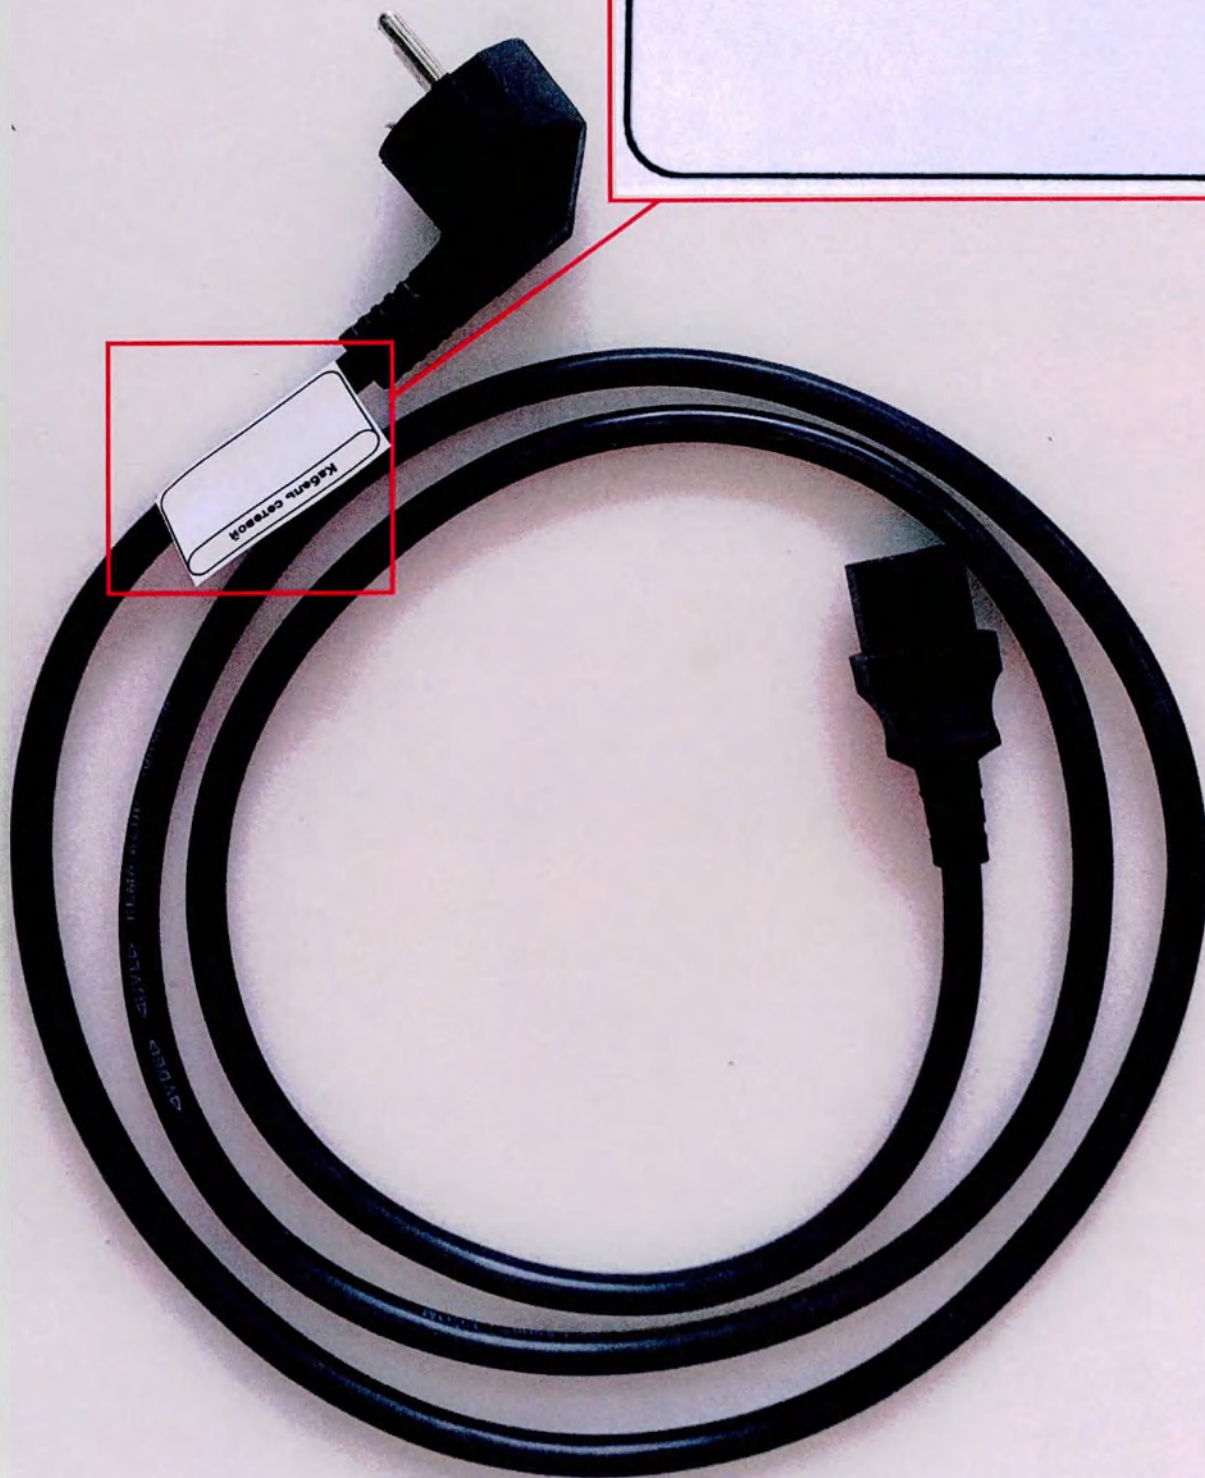


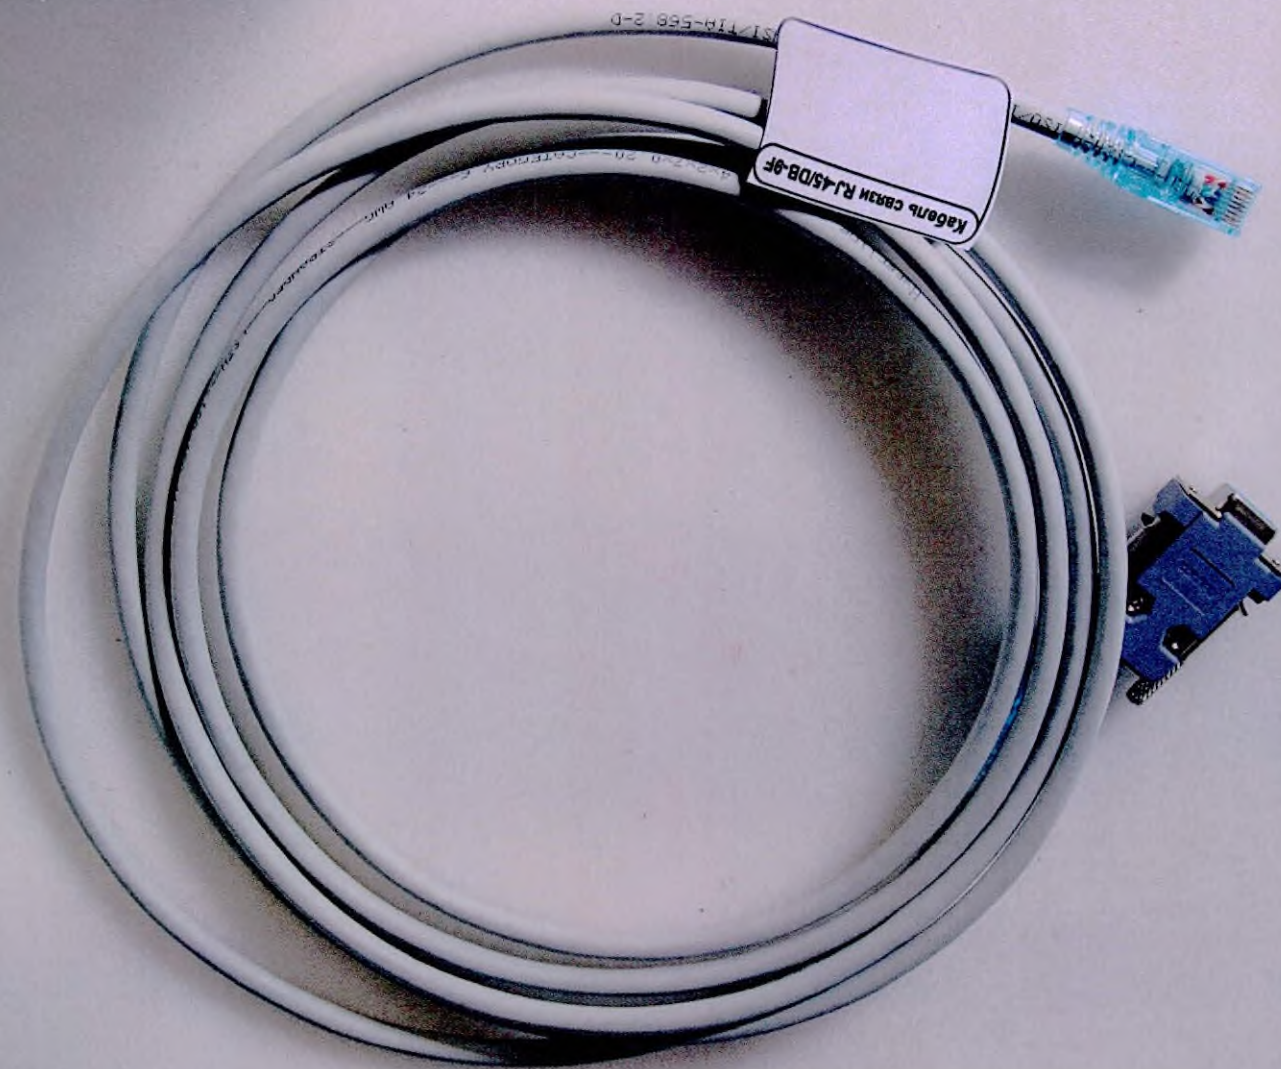

**Провод
защитного заземления**



Смазывающая жидкость для полотна

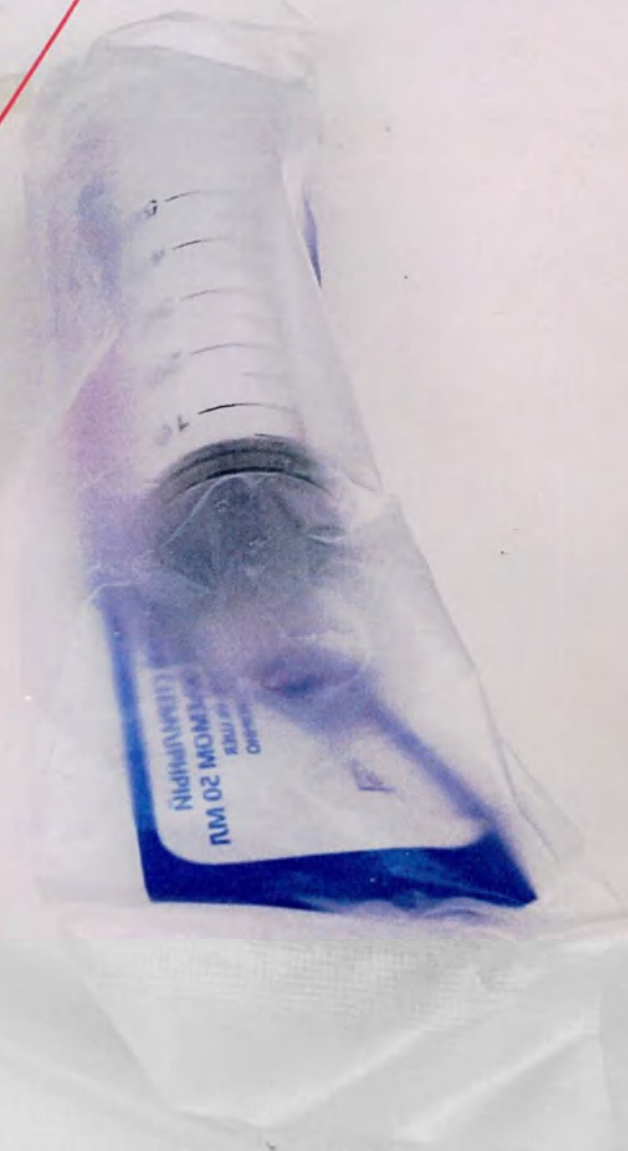

**Жилет для поддержания
пациента
размер детский**



стирка с вещами,
схожими по цвету



**Жилет для поддержания
пациента
размер подростковый**



стирка с вещами,
схожими по цвету



**Жилет для поддержания
пациента
размер взрослый 1**



стирка с вещами,
схожими по цвету




**Жилет для поддержания
пациента
размер взрослый 2**



стирка с вещами,
схожими по цвету






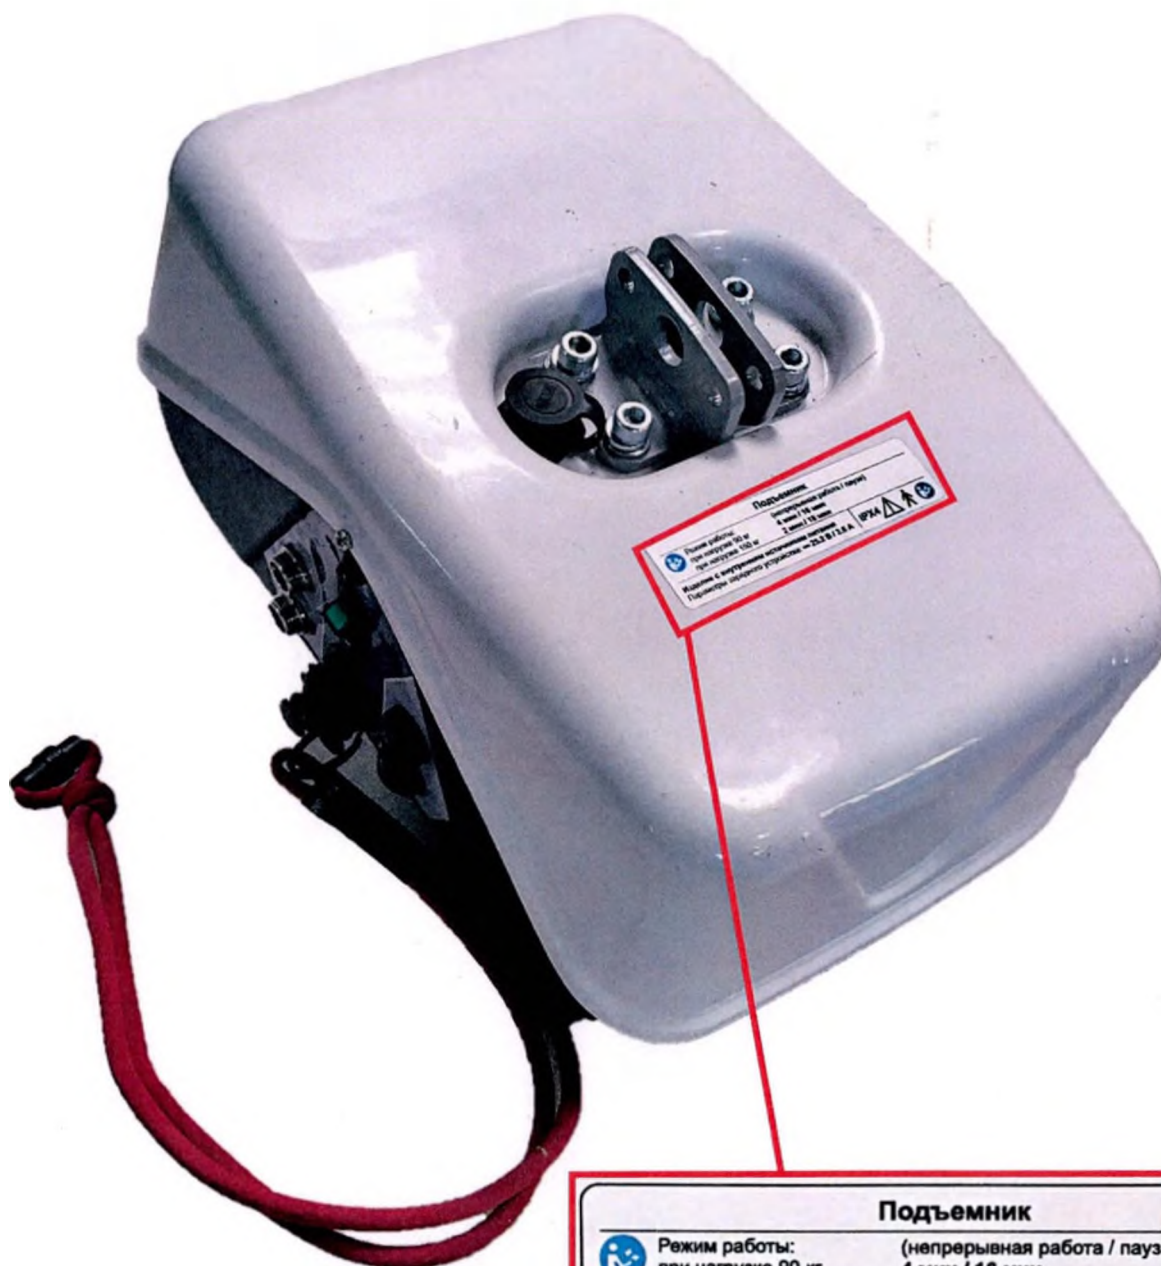



Подъемник
 Максимальная рабочая нагрузка
 90 кг / 15 мин
 150 кг / 2 мин / 18 мин
 IPX4


Подъемник	
 Режим работы: при нагрузке 90 кг при нагрузке 150 кг	(непрерывная работа / пауза) 4 мин / 16 мин 2 мин / 18 мин
Изделие с внутренним источником питания Параметры зарядного устройства: — 25.2 В / 2.8 А	
IPX4   	

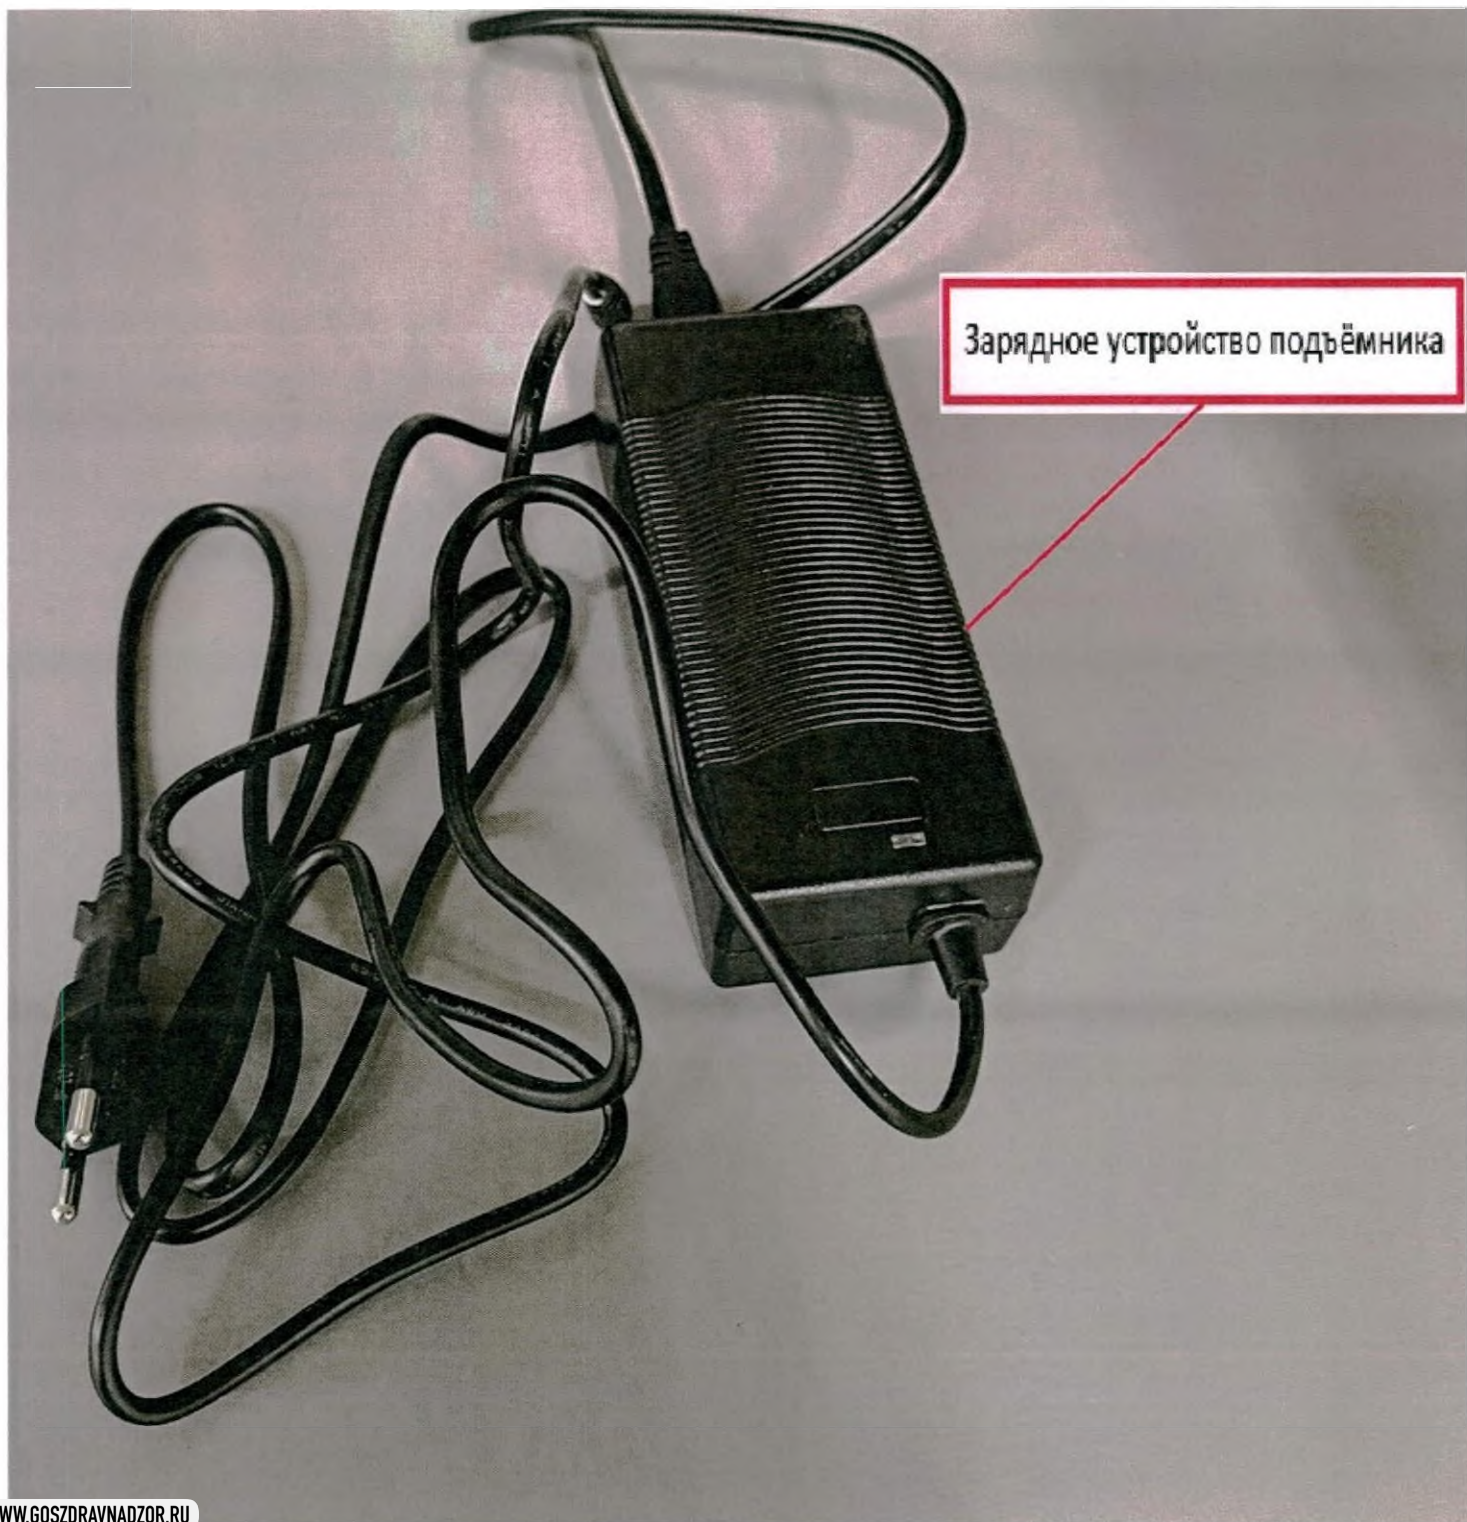

Зарядное устройство подъёмника

Пульт управления
подъемником

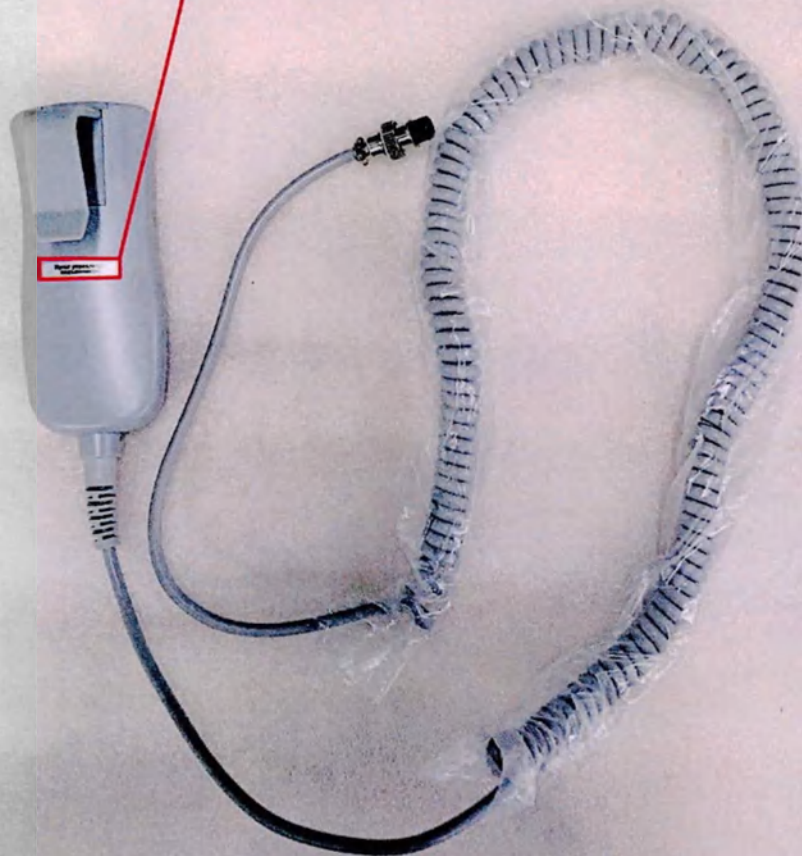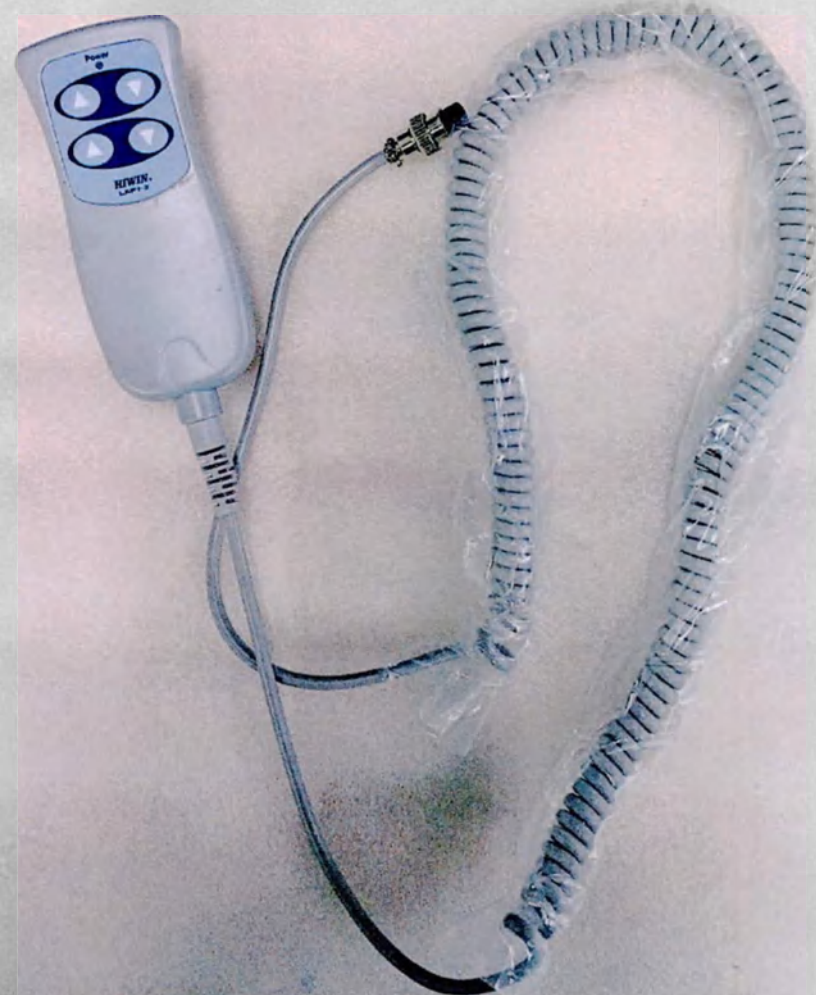

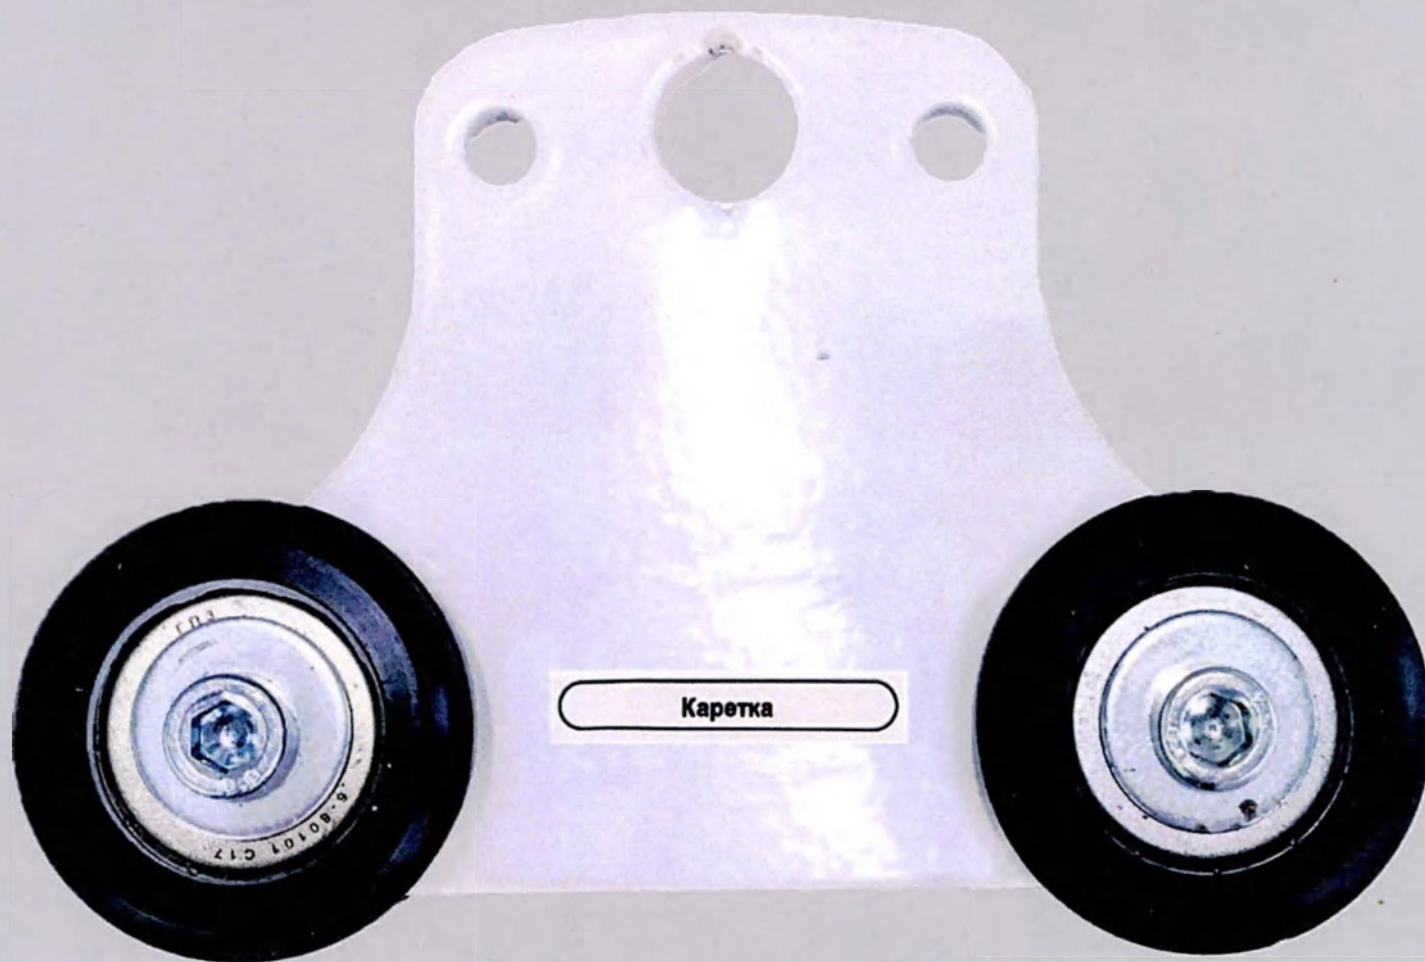

Каретка



Каретка для рельсового
блока зарядного
устройства

**Каретка для рельсового
блока зарядного
устройства**



Рельсовый блок
зарядного устройства

**Рельсовый блок
зарядного устройства**




Напольная конструкция
L4м



**Напольная конструкция
L3м**





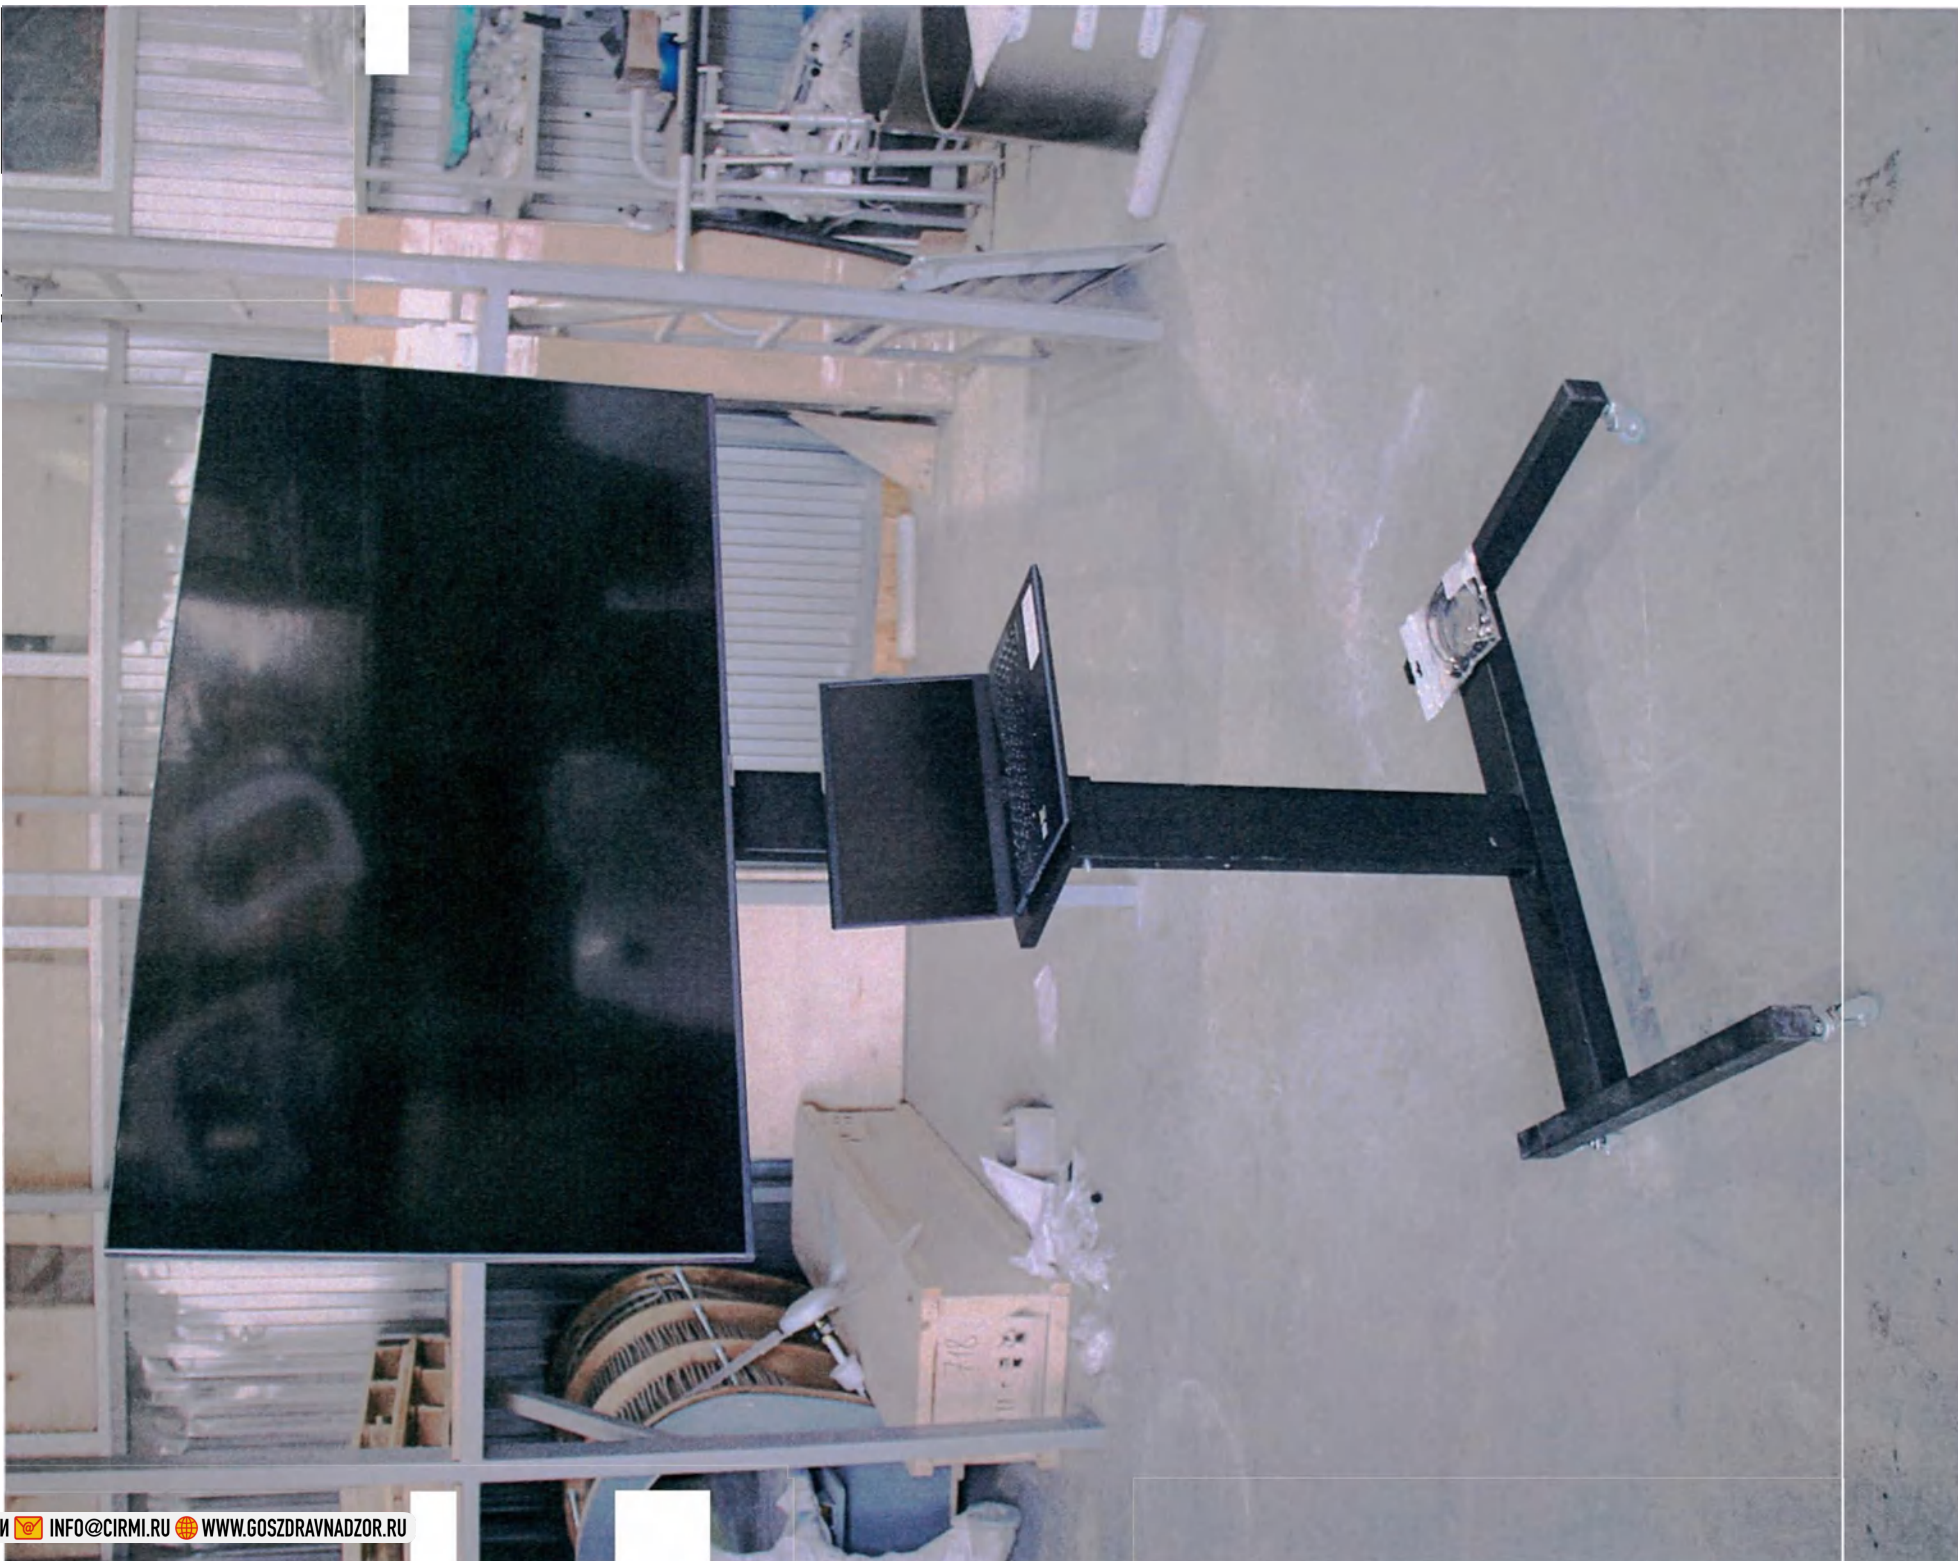






Система визуализации «МАДИС»
по ТУ 26.20.14-012-68709709-2019

Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

Заводской
номер:



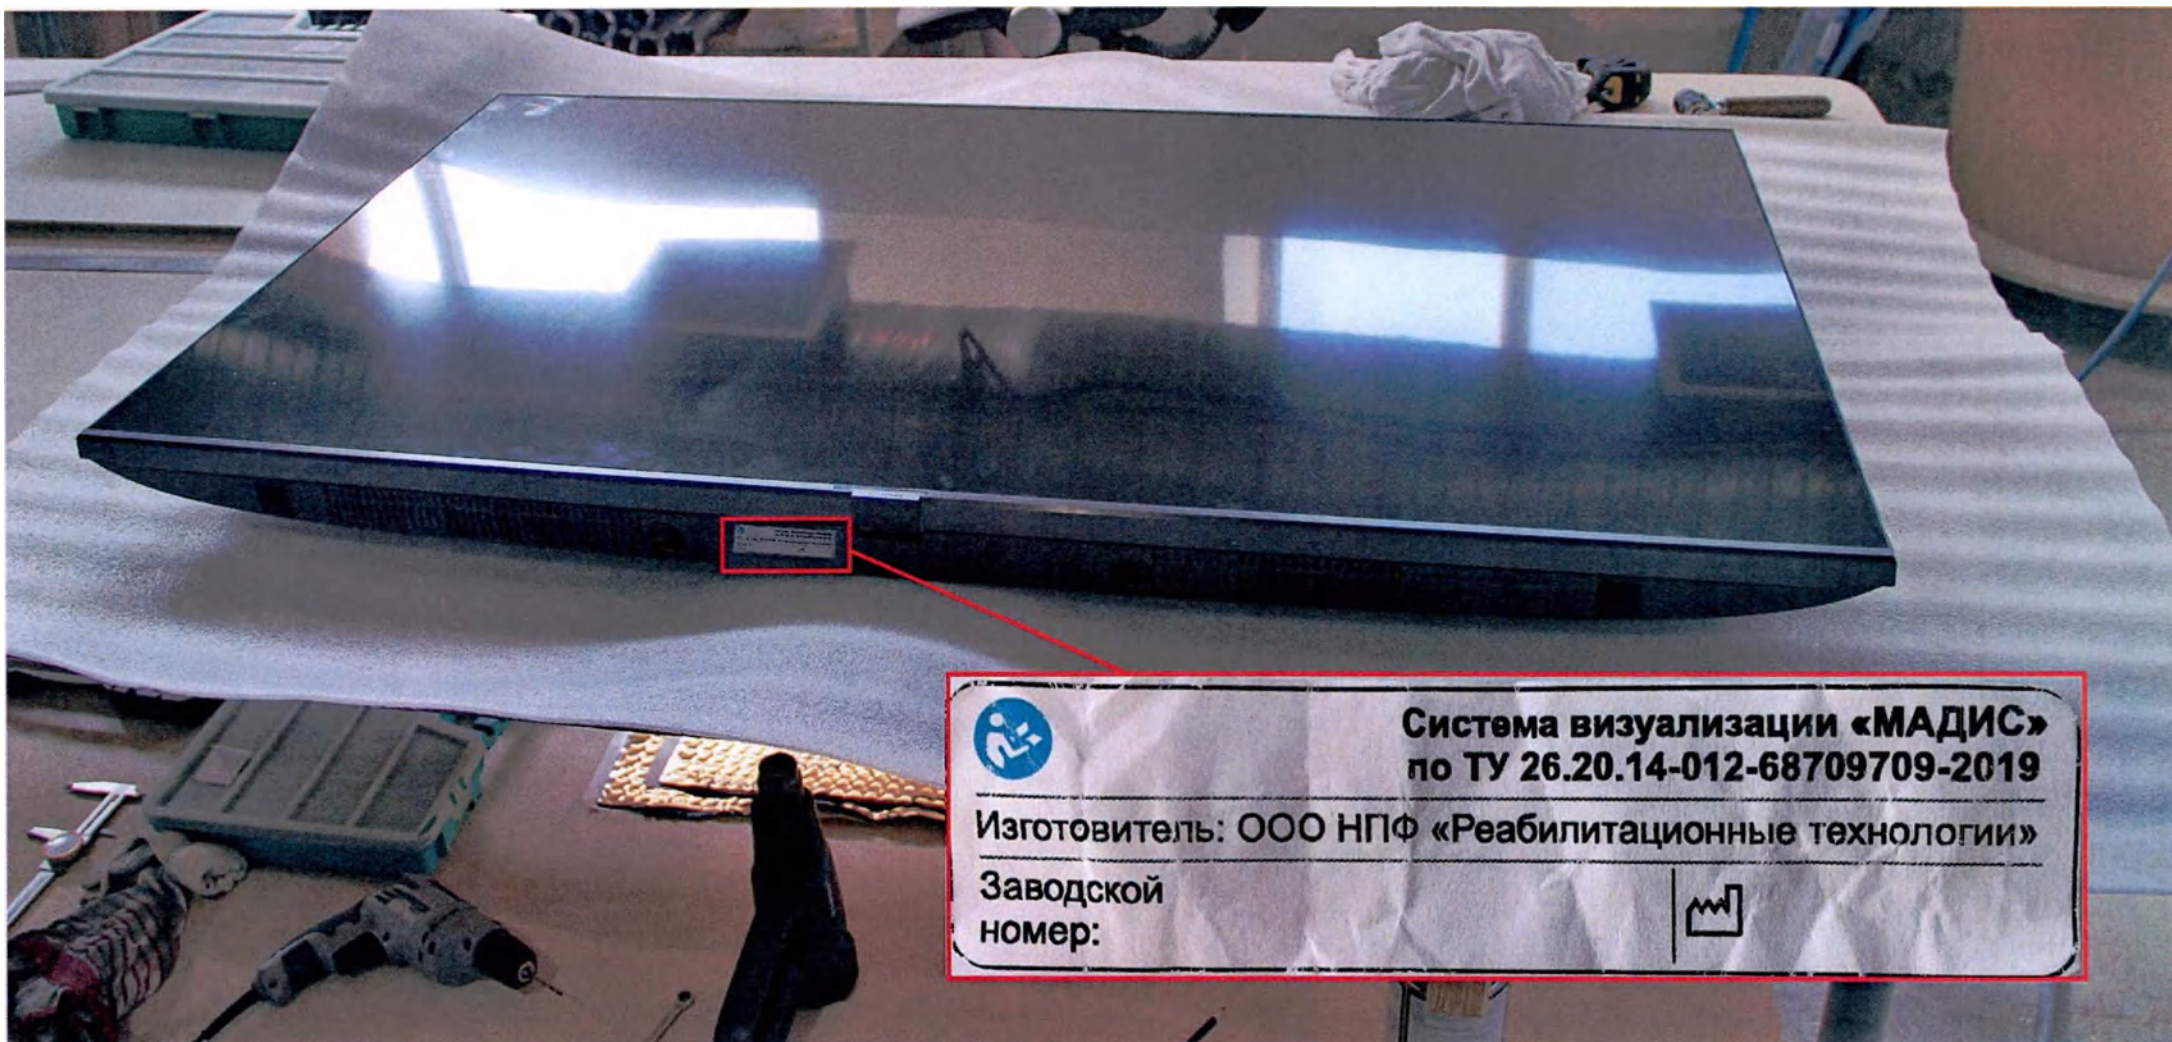

**Система визуализации «МАДИС»
по ТУ 26.20.14-012-68709709-2019**

Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

Заводской
номер:






 Система визуализации «МАДИС»
по ТУ 26.20.14-012-68709709-2019

Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

Заводской номер: 



Изготовитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии»


Заводской
номер:







	Система разгрузки	
	Режим работы: 2 мин / 11 мин (непрерывная работа / пауза)	



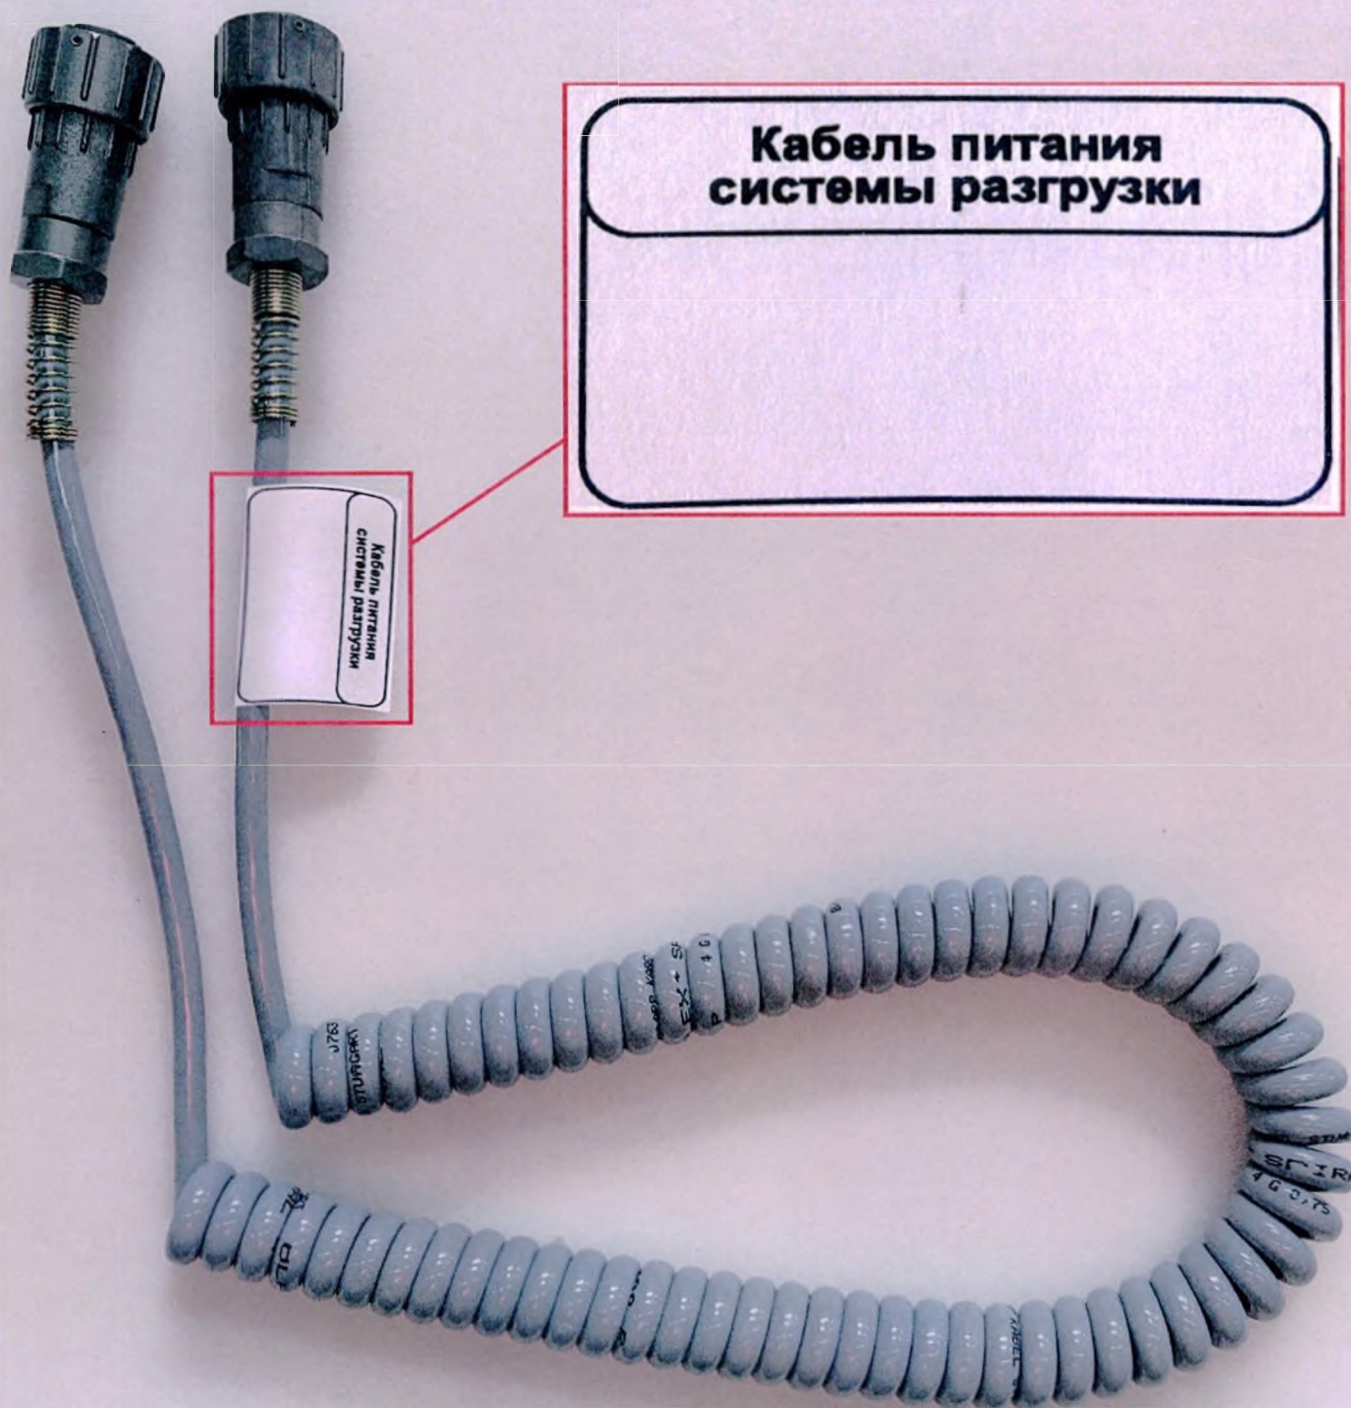

**Кабель питания
системы разгрузки**

Кабель питания
системы разгрузки

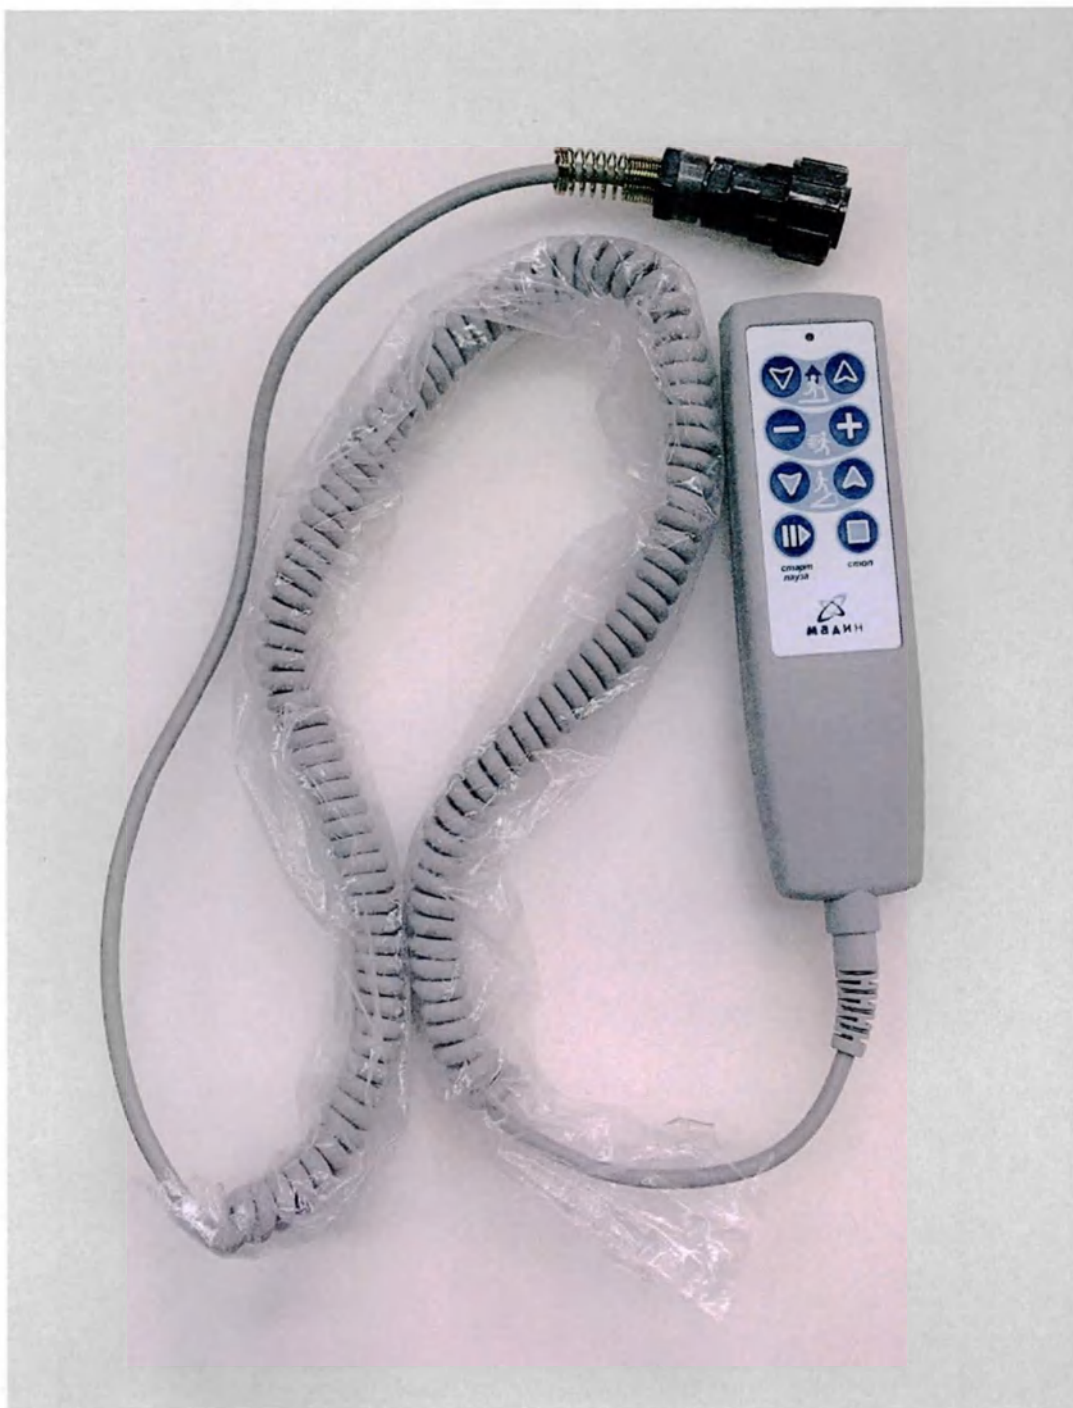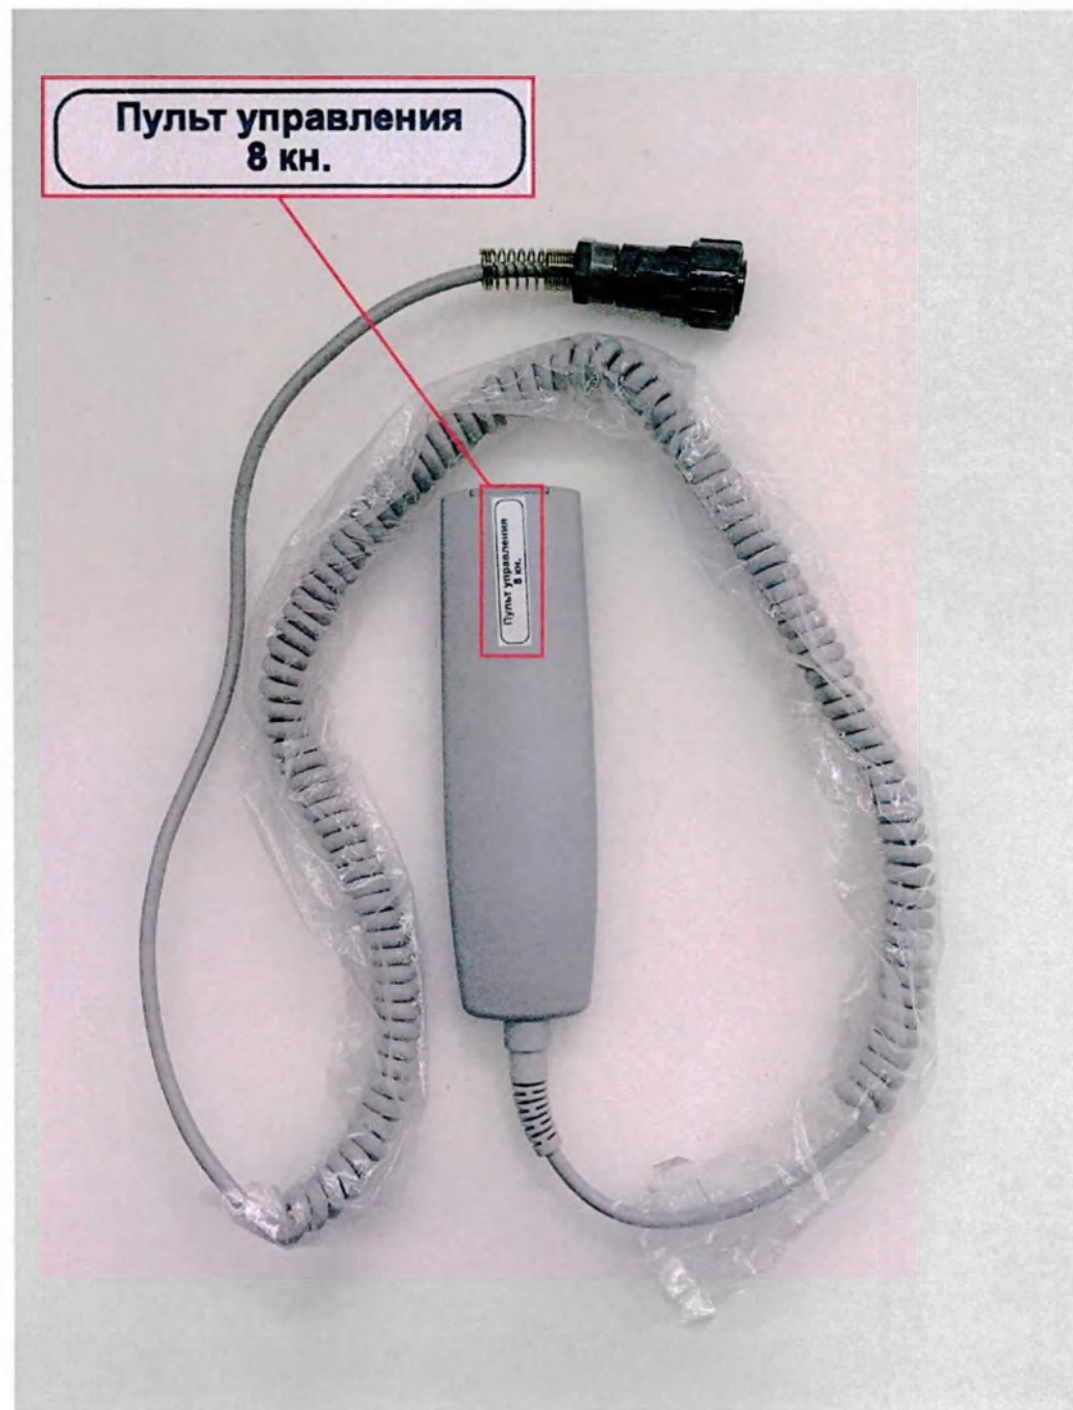



Роботизированный комплекс для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей «NeuroHelper», модификация «Стандартный с ФЭС 16 с подключением для ФЭС на спинном модуле экзоскелета – опция [С].

Производитель: ООО НПФ «Реабилитационные технологии»

Заводской номер: 56

ТУ 32.50.50-019-68709709-2022





ООО НПФ «Реабилитационные технологии»
 Роботизированный комплекс для локомоторной терапии
 и реабилитации нижних конечностей «NeuroHelper»
 по ТУ 32.50.50-019-68709709-2022

Модификация «Стандартный»

Номинальное напряжение питания: 230 В ~
 Номинальная частота напряжения питания: 50 Гц
 Максимальная потребляемая мощность: 2.5 кВт·А

⚙️ Режим работы: 8 ч / 1 ч (непрерывная работа / пауза)
 В качестве резервного источника питания системы разгрузки
 используются свинцово-кислотные аккумуляторы

⚠️ При работе необходимо обеспечить свободный доступ
 воздуха к вентиляционным отверстиям

Заводской номер:

⚡ ⚠️ ⚠️ ⚠️ ⚠️



ЛИТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
 Аппарат для локомоторной терапии
 от компаний «МедотНейра»
 0-019-68709709-2022

Модель «Расширенный»

Питания:	230 В ~
Частота питания:	50 Гц
Мощность:	2.5 кВт-А

Ч (непрерывная работа / пауза)

обеспечить свободный доступ
к отверстиям

Директор ООО «НПФ
Реабилитационные технологии»
Емельянов А.В.



принято, пронумеровано, скреплено
печатью 120 лист(ов)