

СОГЛАСОВАНО

Директор центра постгеномных технологий Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Федерального медико-биологического агентства (ФГБУ «НЦП» ФМБА России)

«03»  2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

набора реагентов для обнаружения и количественного определения
ДНК микобактерий туберкулезного комплекса
методом полимеразной цепной реакции
с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
«АмплиТест® МБТ»

 Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства
(ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

Набор реагентов для обнаружения и количественного определения ДНК микобактерий
туберкулезного комплекса методом полимеразной цепной реакции
с гибридационно-флуоресцентной детекцией

«АмплиТест® МБТ», форма 1    

«РИБО-преп ТБ» вариант 100 - комплект реагентов для экстракции РНК/ДНК
из биологического материала человека и бактериальных культур  8 °C
2 °C

«ПЦР-комплект» вариант FRT-100 F - комплекс реагентов для амплификации
фрагментов ДНК микобактерий туберкулезного комплекса (*Mycobacterium
tuberculosis complex*) и ДНК ВКО с гибридационно-флуоресцентной детекцией
в режиме «реального времени»  -16 °C
-24 °C

 ПЦР-смесь-FL МБТ

Применять согласно прилагаемой инструкции
При получении разукладывать в соответствии с указанными температурами хранения

 REF T-R024-1-FRT  LOT 221114  2022-11-14  2023-11-14

ТУ 21.20.23-024-01897400-2022


Регистрационный номер:

119121, Российская Федерация, г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14; e-mail: promlab@cspfmba.ru; сайт: www.amplitest.ru



АмплиТест

ФГБУ «ЦСП» ФМБА России
119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 10 стр. 1
Тел.: 8 (499) 246-58-24; факс: 8 (499) 245-03-14
e-mail: info@cspfmba.ru; сайт: www.cspfmba.ru

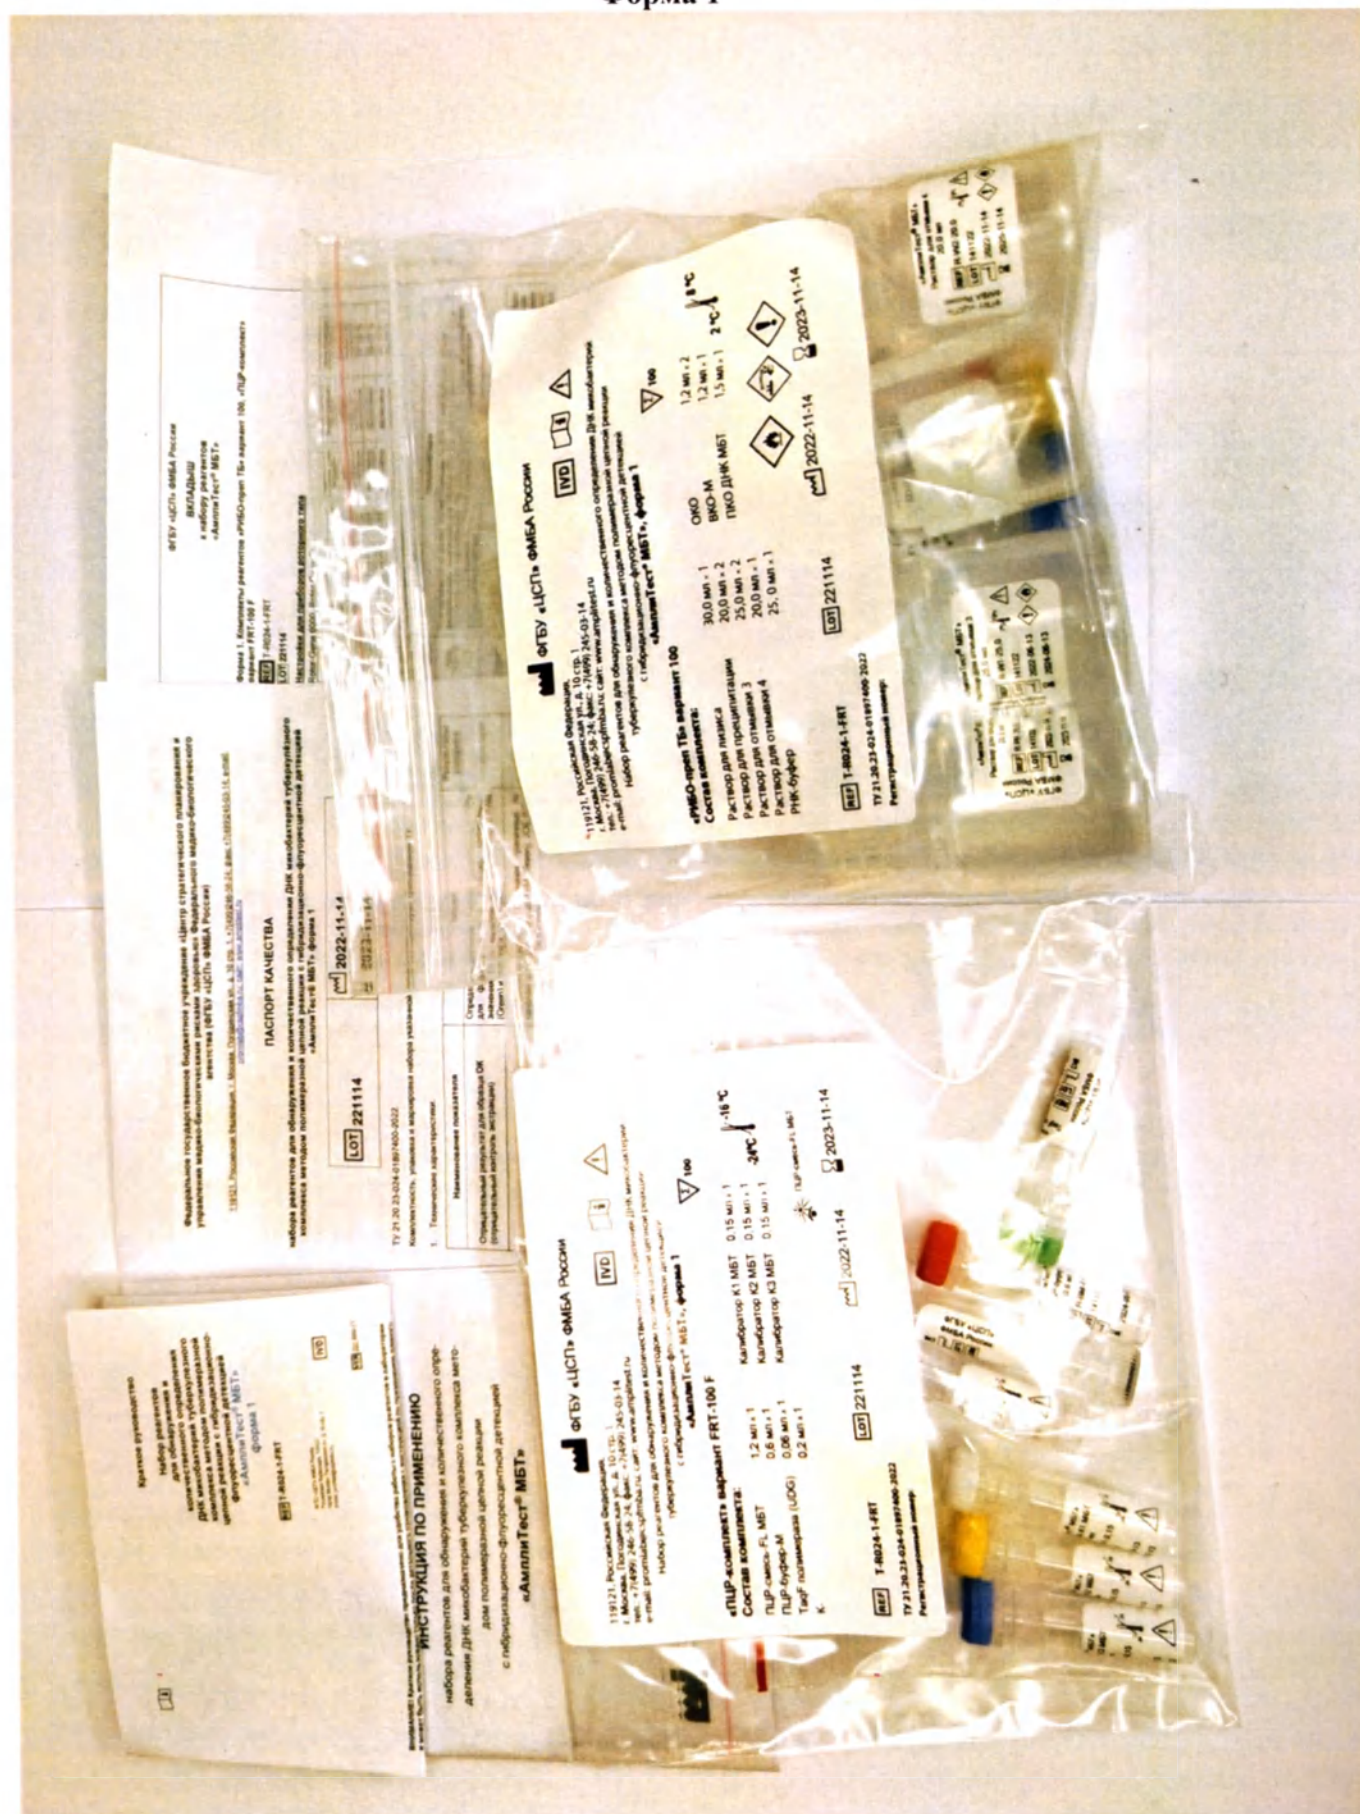

Фотография реагентов набора «АмплиТест® МБТ» («РИБО-преп ТБ», вариант 100),
Форма 1




Фотография реагентов набора «АмплиТест® МБТ» («ПЦР-комплект» вариант FRT-100 F),
Форма 1



Фотография до вскрытия внешней упаковки набора реагентов «АмплиТест® МБТ»,
Форма 2




Фотография после вскрытия внешней упаковки набора реагентов «АмплиТест® МБТ»,
Форма 2

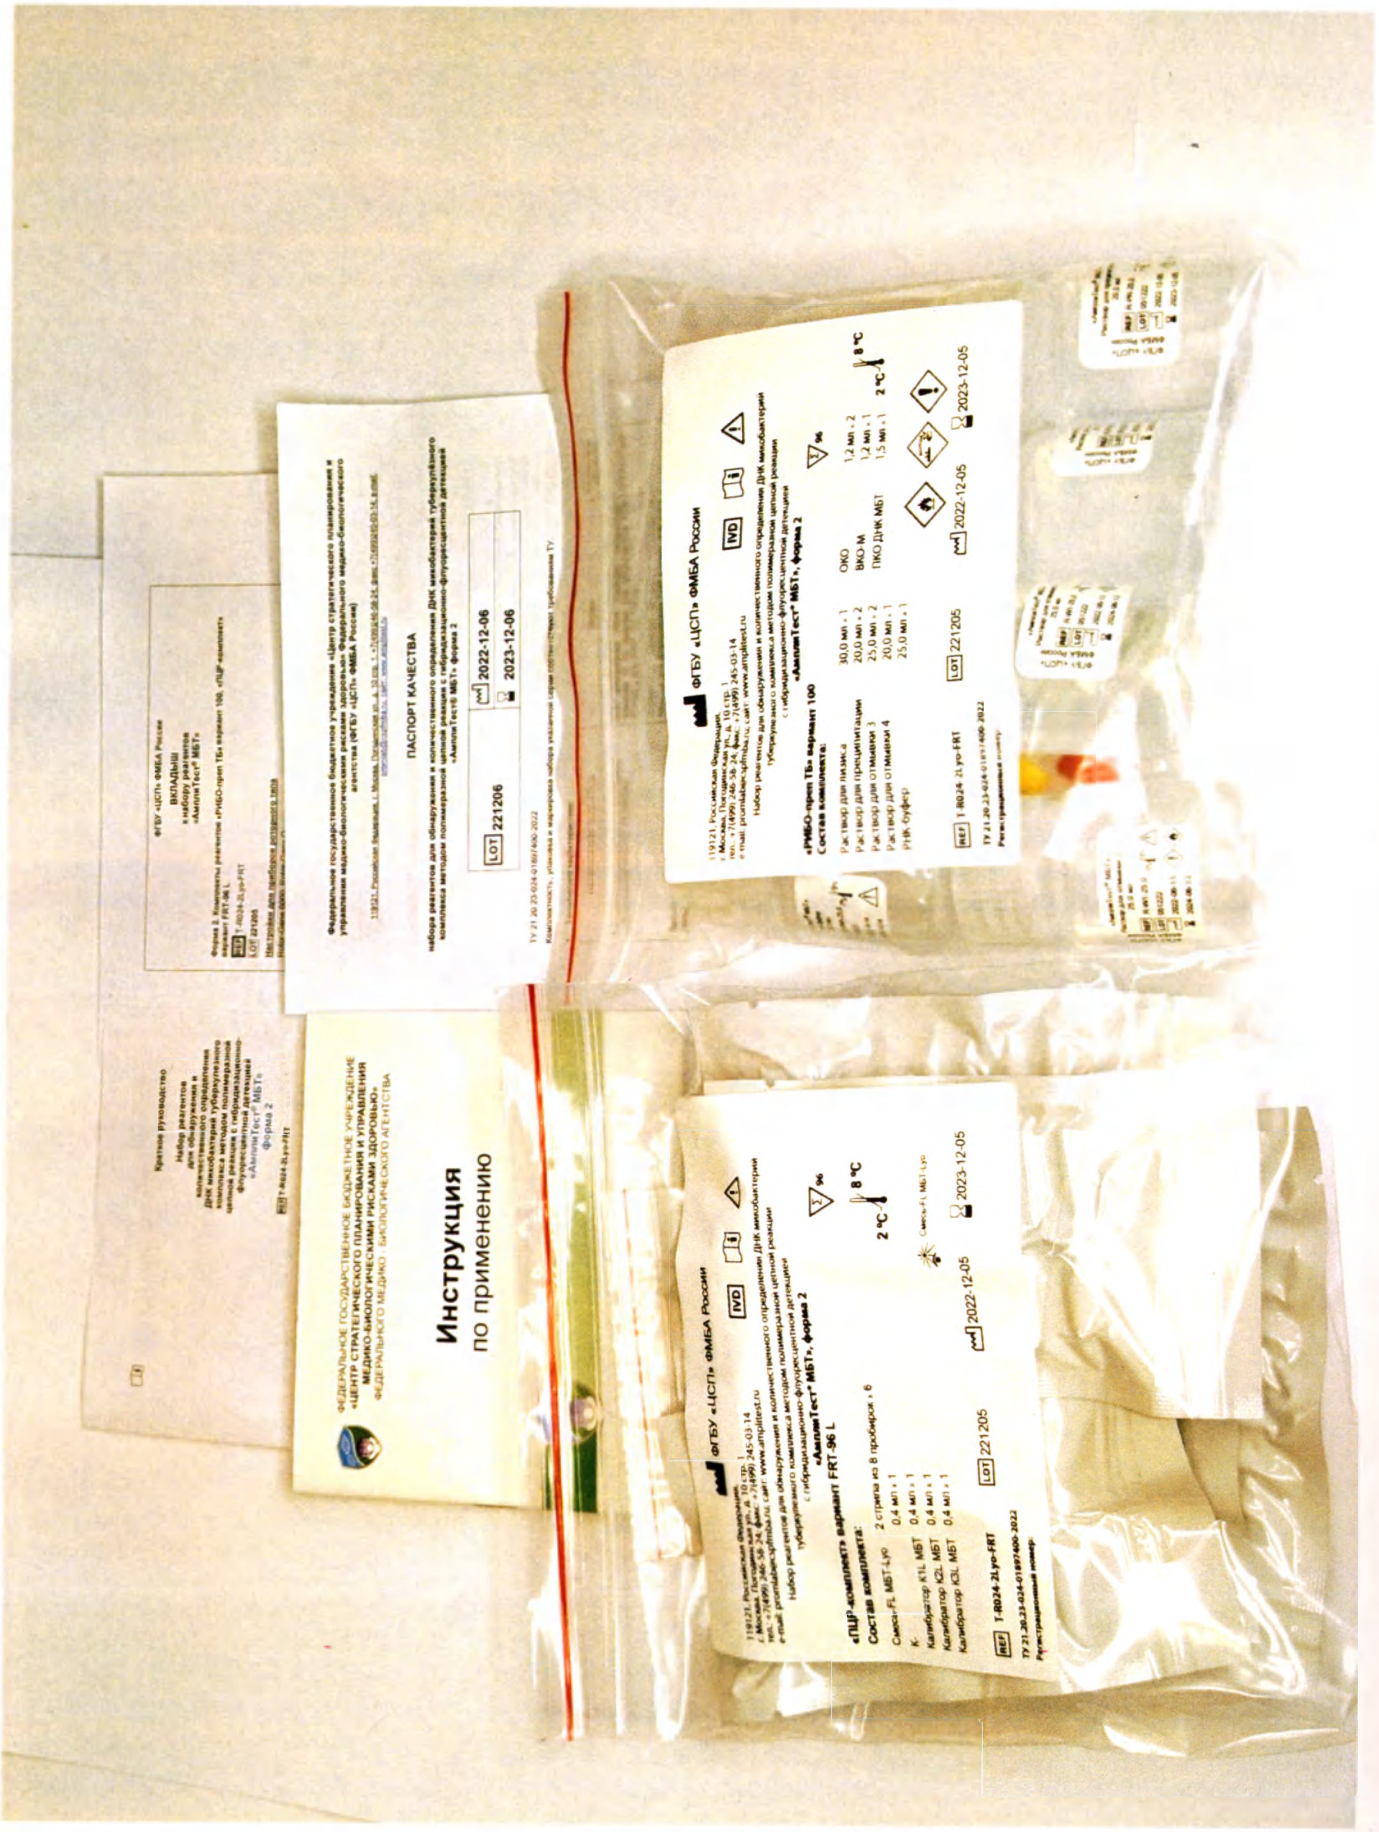


Фотография реагентов набора «АмплиТест® МБТ» (РИБО-преп ТБ, вариант 100),
Форма 2




Фотография реагентов набора «АмплиТест® МБТ» («ПЦР-комплект» вариант FRT-96 L), Форма 2

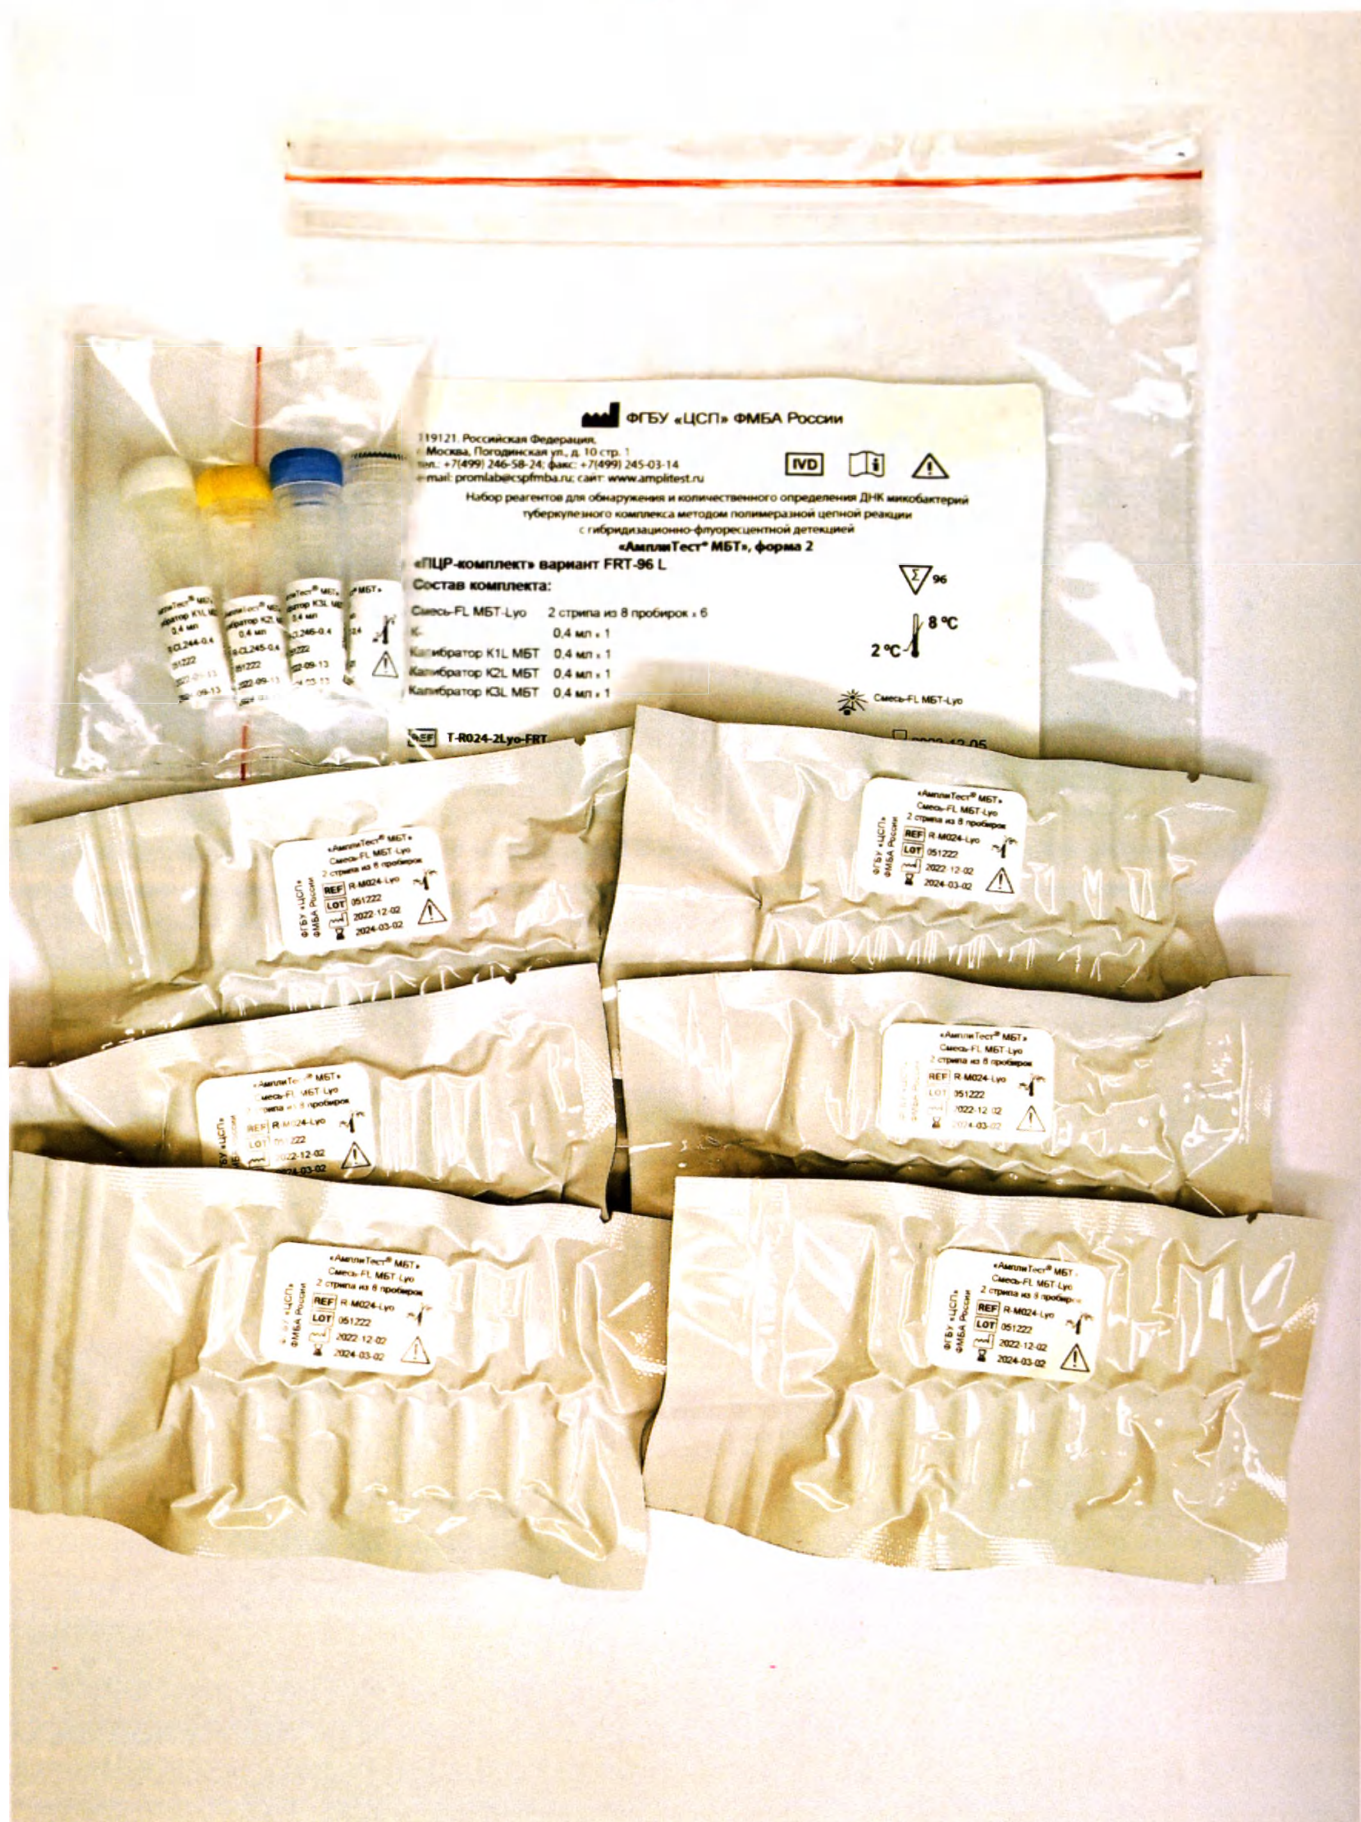

**Фотография до вскрытия внешней упаковки набора реагентов «АмплиТест® МБТ»,
Форма 3**

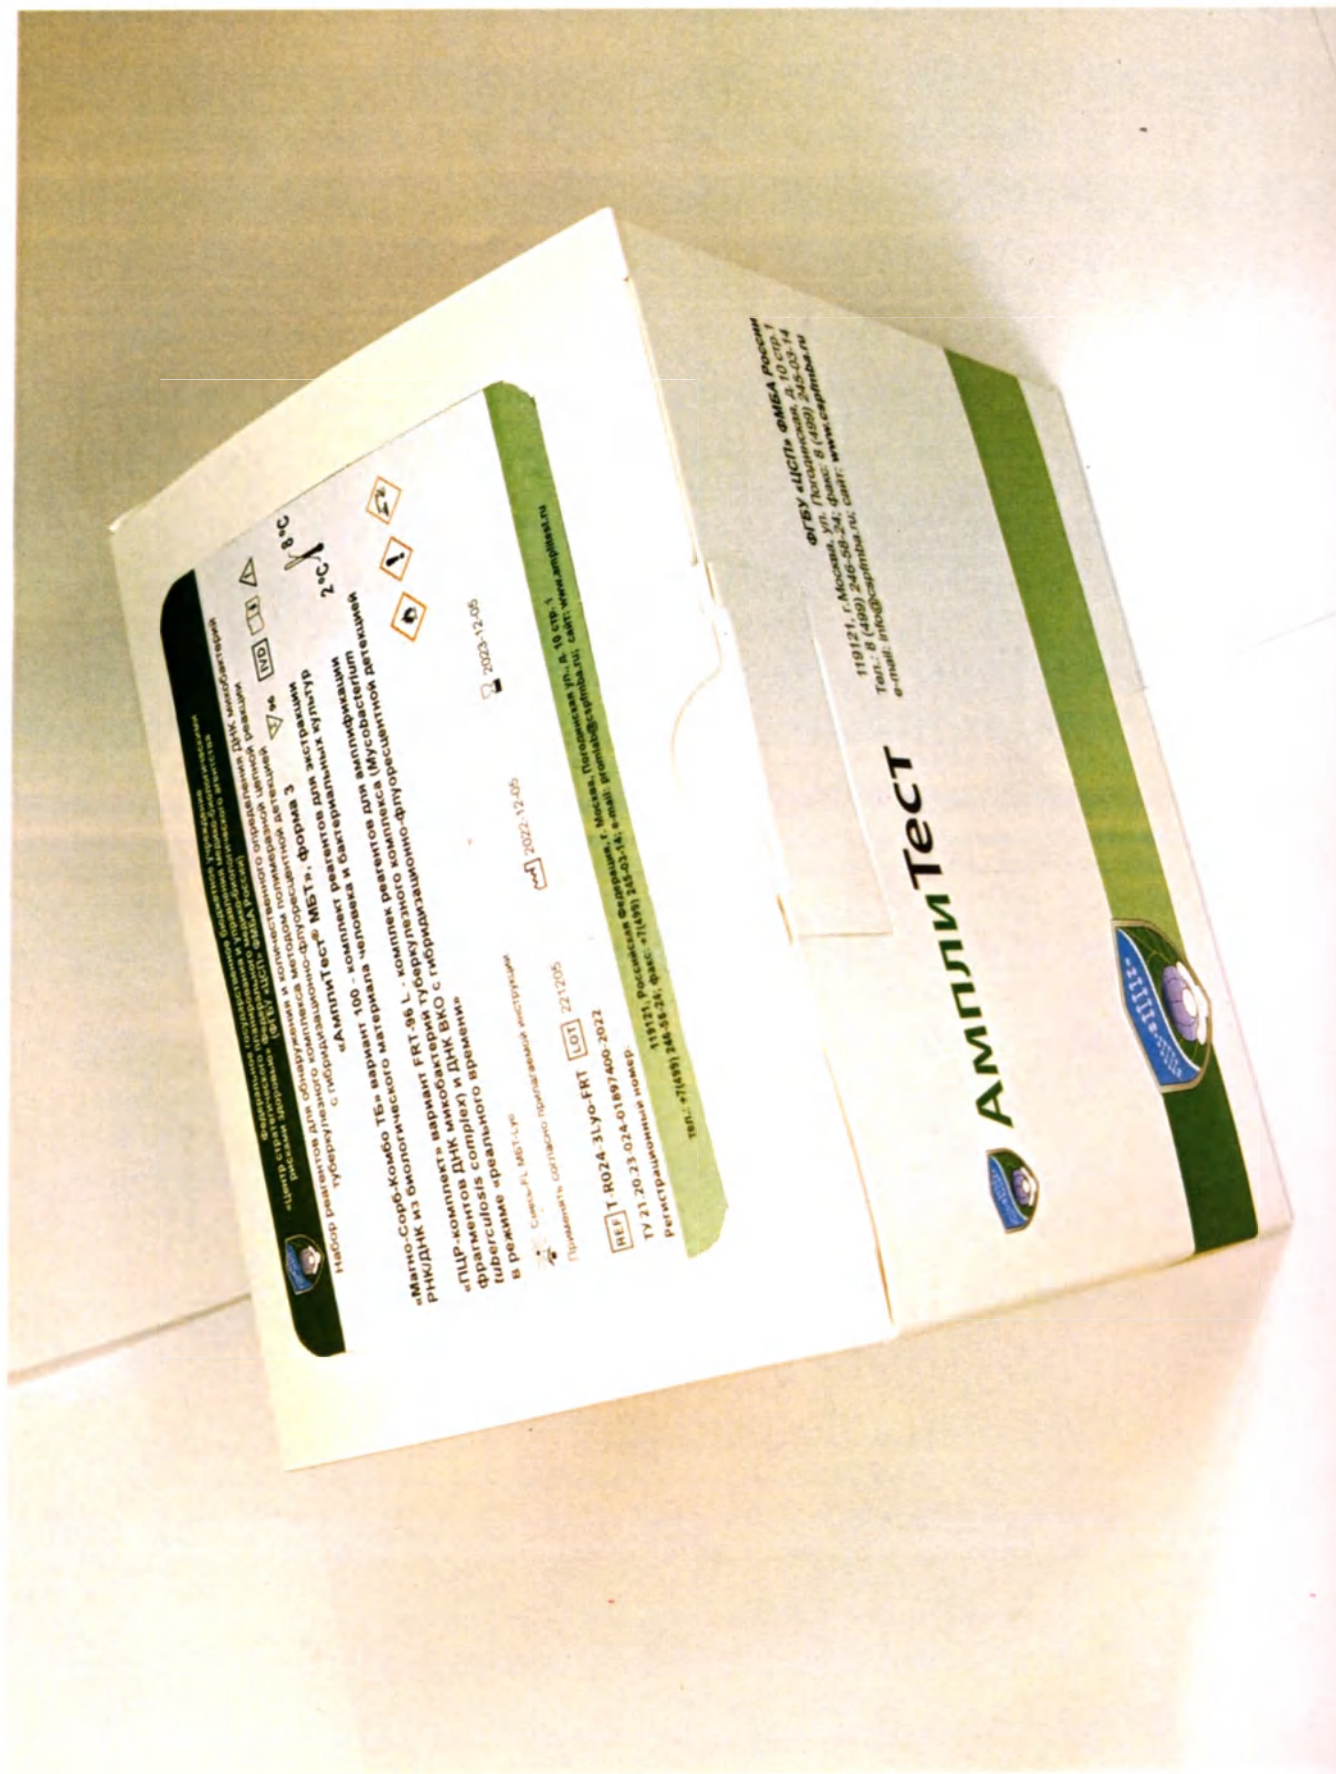

Фотография после вскрытия внешней упаковки набора реагентов «АмплиТест® МБТ»,
Форма 3

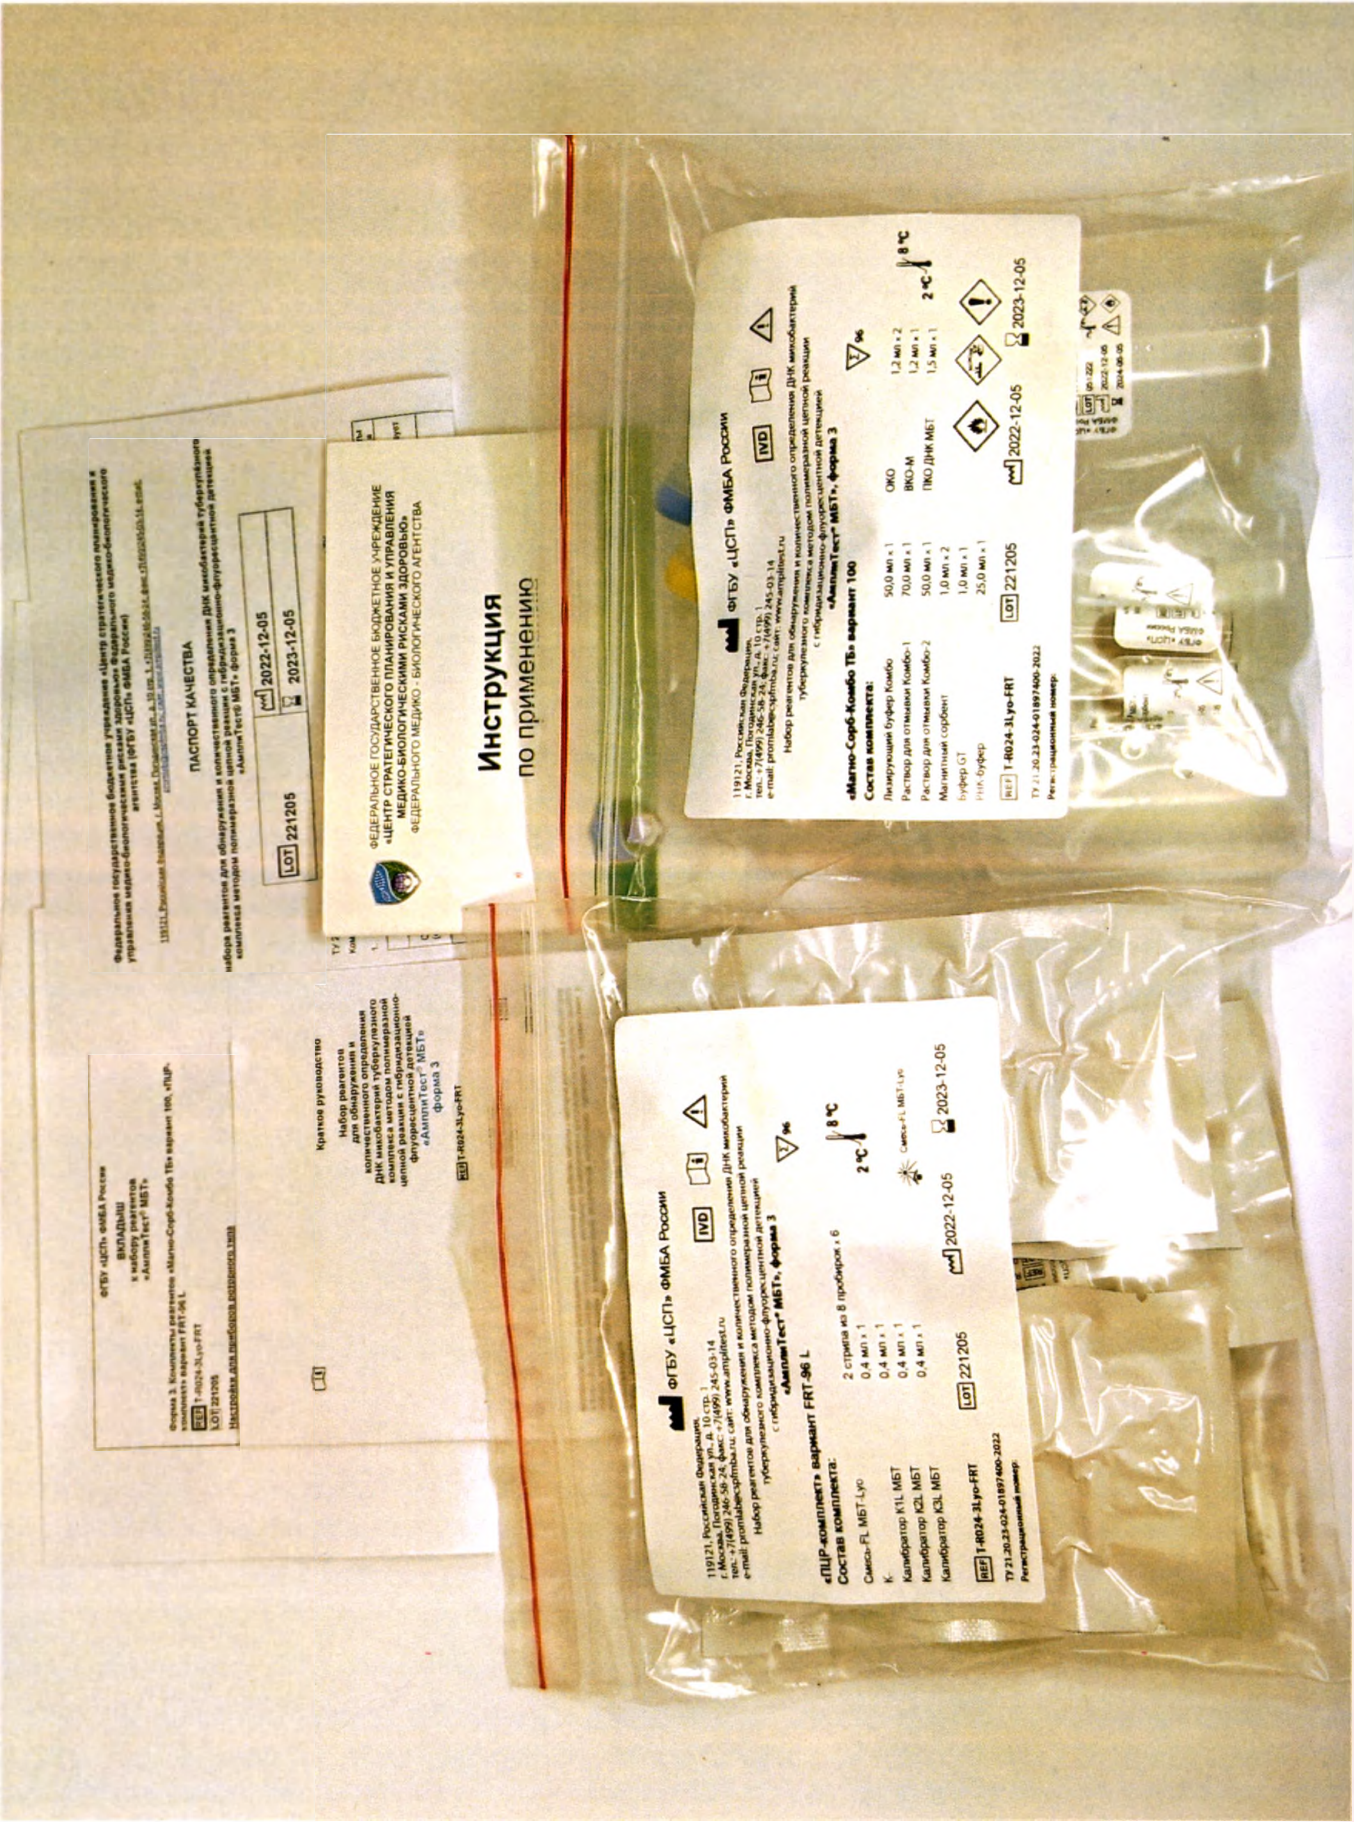

Фотография реагентов набора «АмплиТест® МБТ» (Магно-Сорб-Комбо ТБ, вариант 100),
Форма 3



Фотография реагентов набора «АмплиТест® МБТ» («ПЦР-комплект» вариант FRT-96 L),
Форма 3



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 13 лист 26

Директор центра постгеномных технологий ФГБУ «ЦСП»
ФМБА России

Г.А. Шипулин

