

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «КВАЗАР»

А.В. Туголуков

«15» мая 2023г.



Фотографические изображения и макеты маркировки

Комплекс аппаратно-программный "ЭСМО - электронная система медицинских осмотров (КАП "ЭСМО") по ТУ 26.60.12-001-29448112-2016

I. KB3P.192850.001-02, в составе:

1. Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "Динго В-01", производства «Сентек Корея Корп.», Корея, РУ № ФСЗ 2011/10492.
2. Прибор для оценки функционального состояния ЦНС организма (Бесконтактный пупиллометр) "ЭСМО ПЛ-02".
3. Бесконтактный инфракрасный термометр Bergcom, модели JXB-183, производитель «Джинхинбао Электроник Ко, Лтд», Китай, РУ РЗН 2013/737.
4. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой, модели: ТМ-2655Р, «Эй энд ДИ Компани, Лимитед», Япония, РУ № РЗН 2013/283.
5. Антивандальное кресло.
6. Корпус в антивандальном исполнении со встроенным системным блоком управления.
7. Считыватель карт.
8. USB WEB Камера.
9. Монитор с сенсорным экраном.
10. Программное обеспечение "ЭСМО - электронная система медицинских осмотров".
11. Эксплуатационная документация:
 - 11.1. Руководство по эксплуатации.
 - 11.2. Паспорт.

Бесконтактный инфракрасный термометр Bergson, модели JXB-183, производитель «Джинхинбао Электроник Ко, Лтд», Китай, РУ РЗН 2013/737

Прибор для оценки функционального состояния ЦНС организма (Бесконтактный пупиллометр) "ЭСМО ПЛ-02"

Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе «Динго В-01», производства «Сентек Корея Корп.», Корея, РУ № ФСЗ 2011/10492

USB WEB-камера

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой, модели: ТМ-2655Р, «Эй энд Ди Компани, Лимитед», Япония, РУ № РЗН 2013/283

Монитор с сенсорным экраном

Считыватель карт

Корпус в антивандальном исполнении со встроенным системным блоком управления

Антивандальное кресло

I. KBЗР.192850.001-02, в составе:

1. Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения "Динго Е-200", производства «Сентек Корея Корп.», Корея, РУ № ФСЗ 2014/1689.
2. Прибор для оценки функционального состояния ЦНС организма (Бесконтактный пупиллометр) "ЭСМО ПЛ-02".
3. Бесконтактный инфракрасный термометр Вегсом, модели JXB-183, производитель «Джинхинбао Электроник Ко, Лтд», Китай, РУ РЗН 2013/737.
4. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой, модели: ТМ-2655Р, «Эй энд ДИ Компани, Лимитед», Япония, РУ № РЗН 2013/283.
5. Антивандальное кресло.
6. Корпус в антивандальном исполнении со встроенным системным блоком управления.
7. Считыватель карт.
8. USB WEB Камера.
9. Монитор с сенсорным экраном.
10. Программное обеспечение "ЭСМО - электронная система медицинских осмотров".
11. Эксплуатационная документация:
 - 11.1. Руководство по эксплуатации.
 - 11.2. Паспорт.

Бесконтактный инфракрасный термометр
Bettsom, модели JXB-183, производитель
«Джинхинбао Электроник Ко, Лтд»,
Китай, РУ РЗН 2013/737

Анализатор концентрации паров этанола в
выдыхаемом воздухе Динго с
принадлежностями, вариант исполнения
"Динго Е-200", производства «Сентек
Корея Корп.», Корея, РУ № ФСЗ 2014/1689

Измеритель артериального давления и
частоты пульса автоматический цифровой,
модели: ТМ-2655Р, «ЭЙ энд ДИ Компани,
Лимитед», Япония, РУ № РЗН 2013/283

Прибор для оценки функционального
состояния ЦНС организма (Бесконтактный
пупиллометр) "ЭСМО ПЛ-02"

USB WEB-камера

Монитор с сенсорным экраном

Считыватель карт

Корпус в антивандальном
исполнении со встроенным
системным блоком управления

Антивандальное кресло

II. KBЗР.192850.001-03, в составе:

1. Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе "Динго В-01", производства «Сентек Корея Корп.», Корея, РУ № ФСЗ 2011/10492.
2. Бесконтактный инфракрасный термометр Вегсом, модели JXB-183, производитель «Джинхинбао Электроник Ко, Лтд», Китай, РУ РЗН 2013/737.
3. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой, модели: ТМ-2655Р, «Эй энд ДИ Компани, Лимитед», Япония, РУ № РЗН 2013/283.
4. Антивандальное кресло.
5. Корпус в антивандальном исполнении со встроенным системным блоком управления.
6. Считыватель карт.
7. USB WEB Камера.
8. Монитор с сенсорным экраном.
9. Программное обеспечение "ЭСМО - электронная система медицинских осмотров".
10. Эксплуатационная документация:
 - 10.1. Руководство по эксплуатации.
 - 10.2. Паспорт.

Бесконтактный инфракрасный термометр
Beigson, модели JXB-183, производитель
«Джинхинбао Электроник Ко, Лтд»,
Китай, РУ РЗН 2013/737

Анализатор паров этанола в
выдыхаемом воздухе «Динго В-01»,
производства «Сентек Корея Корп.»,
Корея, РУ № ФСЗ 2011/10492

Измеритель артериального давления и
частоты пульса автоматический цифровой,
модели: ТМ-2655Р, «Эй энд ДИ Компани,
Лимитед», Япония, РУ № РЗН 2013/283

USB WEB-камера

Монитор с сенсорным экраном

Считыватель карт

Корпус в антивандальном
исполнении со встроенным
системным блоком управления

Антивандальное кресло

II. KBЗР.192850.001-03, в составе:

1. Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения "Динго Е-200", производства «Сентек Корея Корп.», Корея, РУ № ФСЗ 2014/1689.
2. Бесконтактный инфракрасный термометр Вегсом, модели JXB-183, производитель «Джинхинбао Электроник Ко, Лтд», Китай, РУ РЗН 2013/737.
3. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой, модели: ТМ-2655Р, «Эй энд ДИ Компани, Лимитед», Япония, РУ № РЗН 2013/283.
4. Антивандальное кресло.
5. Корпус в антивандальном исполнении со встроенным системным блоком управления.
6. Считыватель карт.
7. USB WEB Камера.
8. Монитор с сенсорным экраном.
9. Программное обеспечение "ЭСМО - электронная система медицинских осмотров".
10. Эксплуатационная документация:
 - 10.1. Руководство по эксплуатации.
 - 10.2. Паспорт.

Бесконтактный инфракрасный термометр
Beigson, модели JXB-183, производитель
«Джинхинбао Электроник Ко, Лтд»,
Китай, РУ РЗН 2013/737

Анализатор концентрации паров этанола в
выдыхаемом воздухе Динго с
принадлежностями, вариант исполнения
"Динго Е-200", производства «Сентек
Корея Корп.», Корея, РУ № ФСЗ 2014/1689

Измеритель артериального давления и
частоты пульса автоматический цифровой,
модели: ТМ-2655Р, «ЭЙ энд ДИ Компани,
Лимитед», Япония, РУ № РЗН 2013/283


Антивандальное кресло

USB WEB-камера


Монитор с сенсорным экраном

Считыватель карт


Корпус в антивандальном
исполнении со встроенным
системным блоком управления


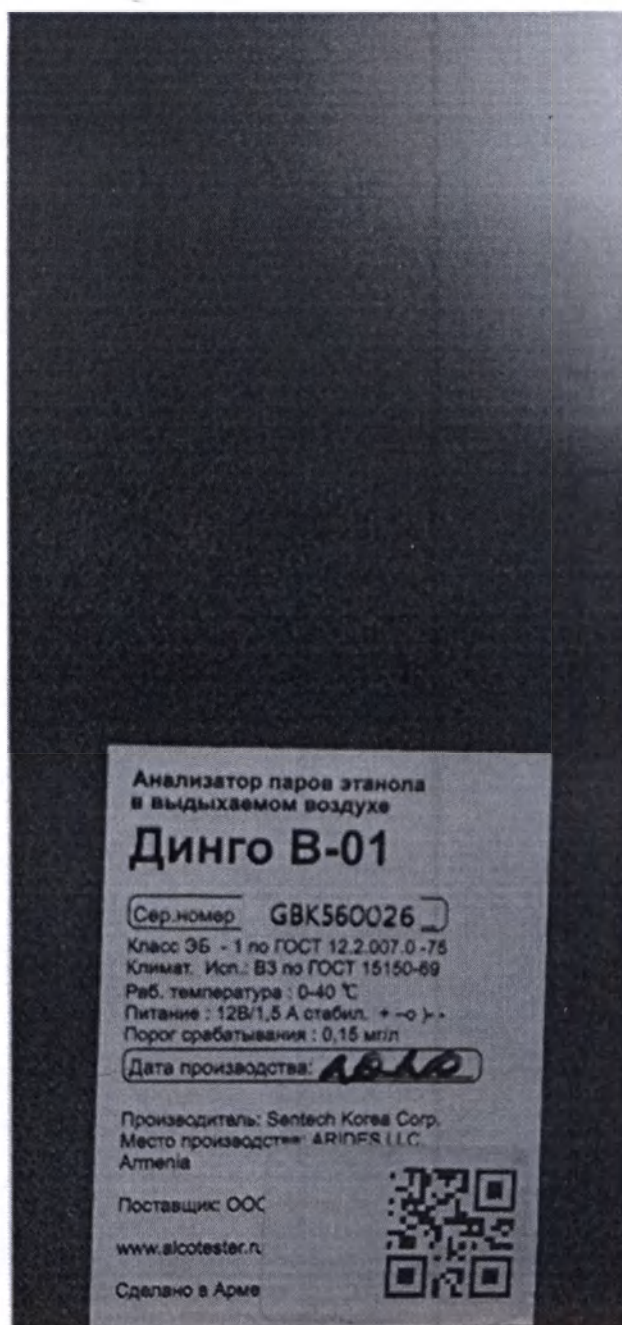


Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностями, вариант исполнения "Динго Е-200", производства «Сентек Корея Корп.», Корея, РУ № ФСЗ 2014/1689.

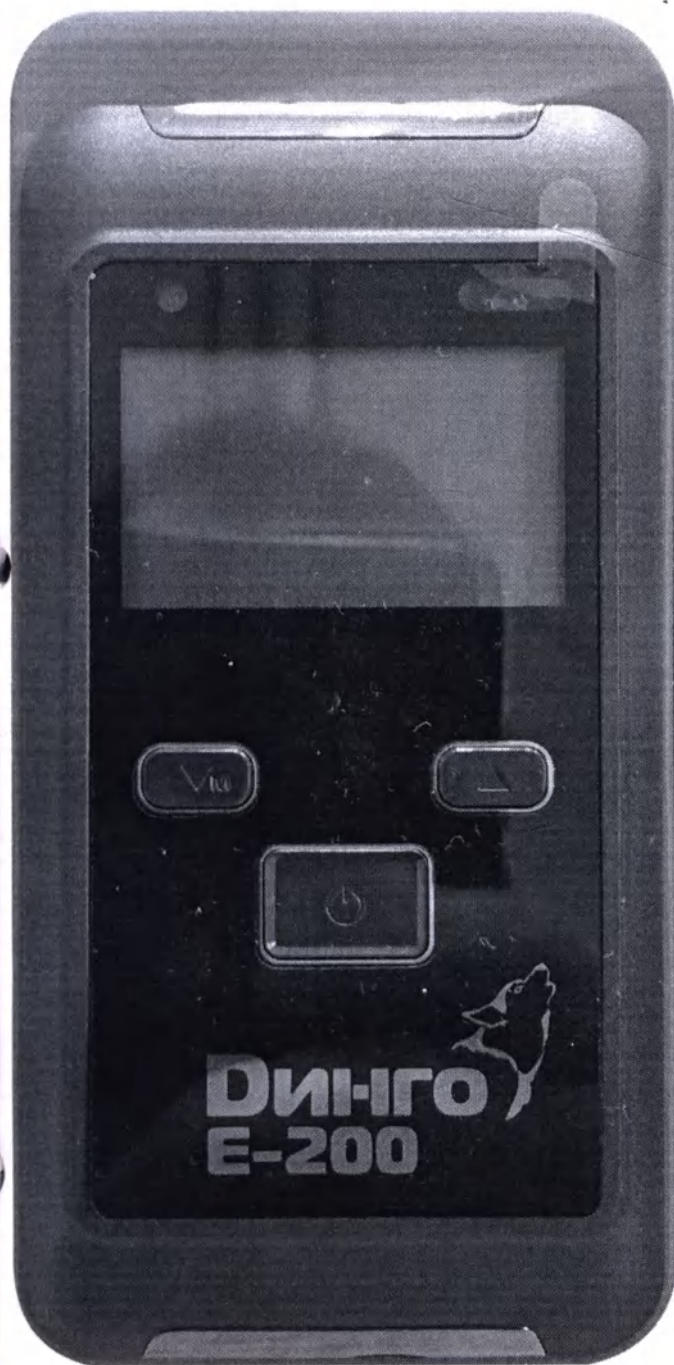

Прибор для оценки функционального состояния ЦНС организма (Бесконтактный пупиллометр) "ЭСМО ПЛ-02".

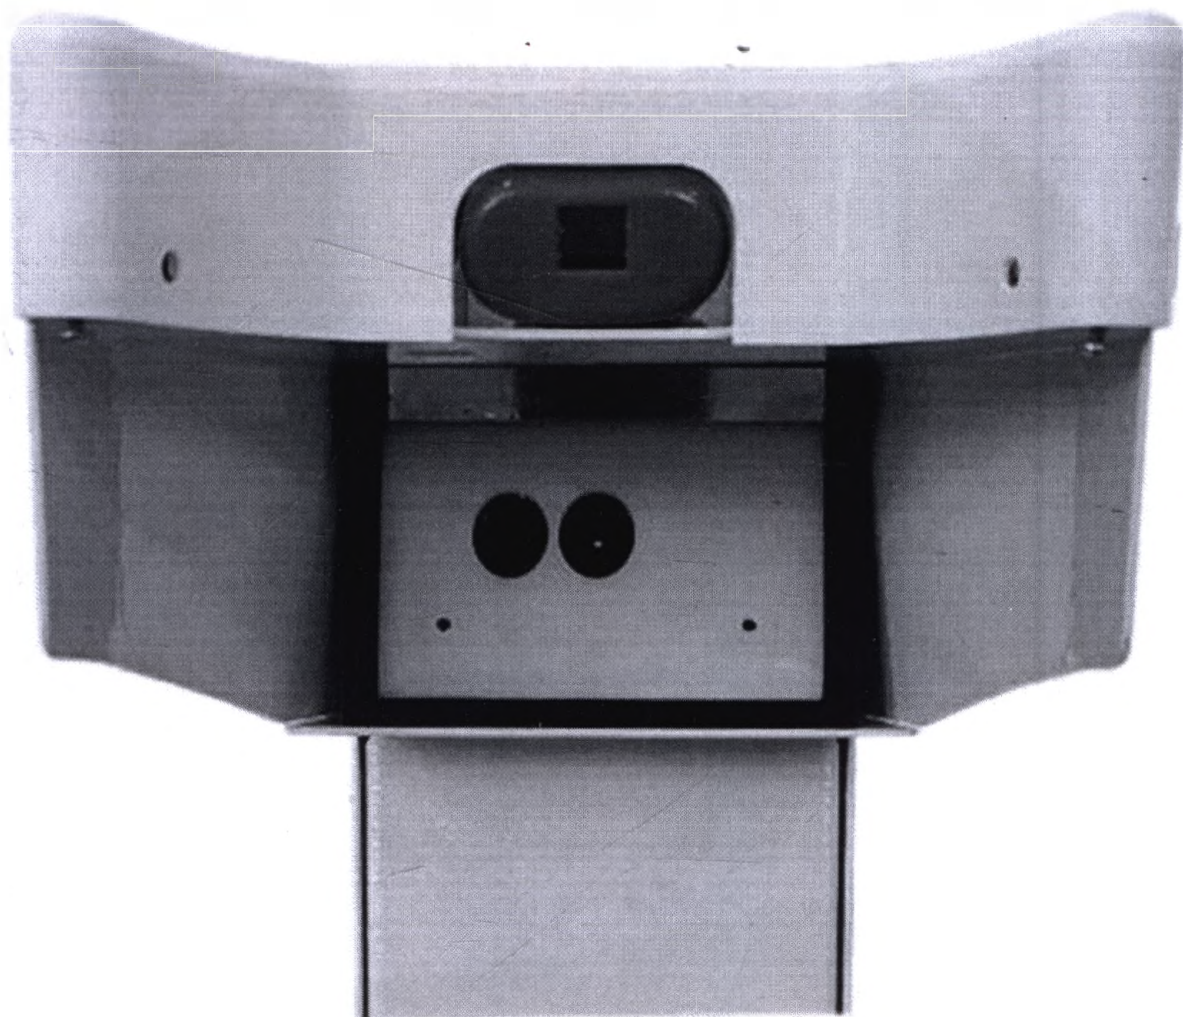

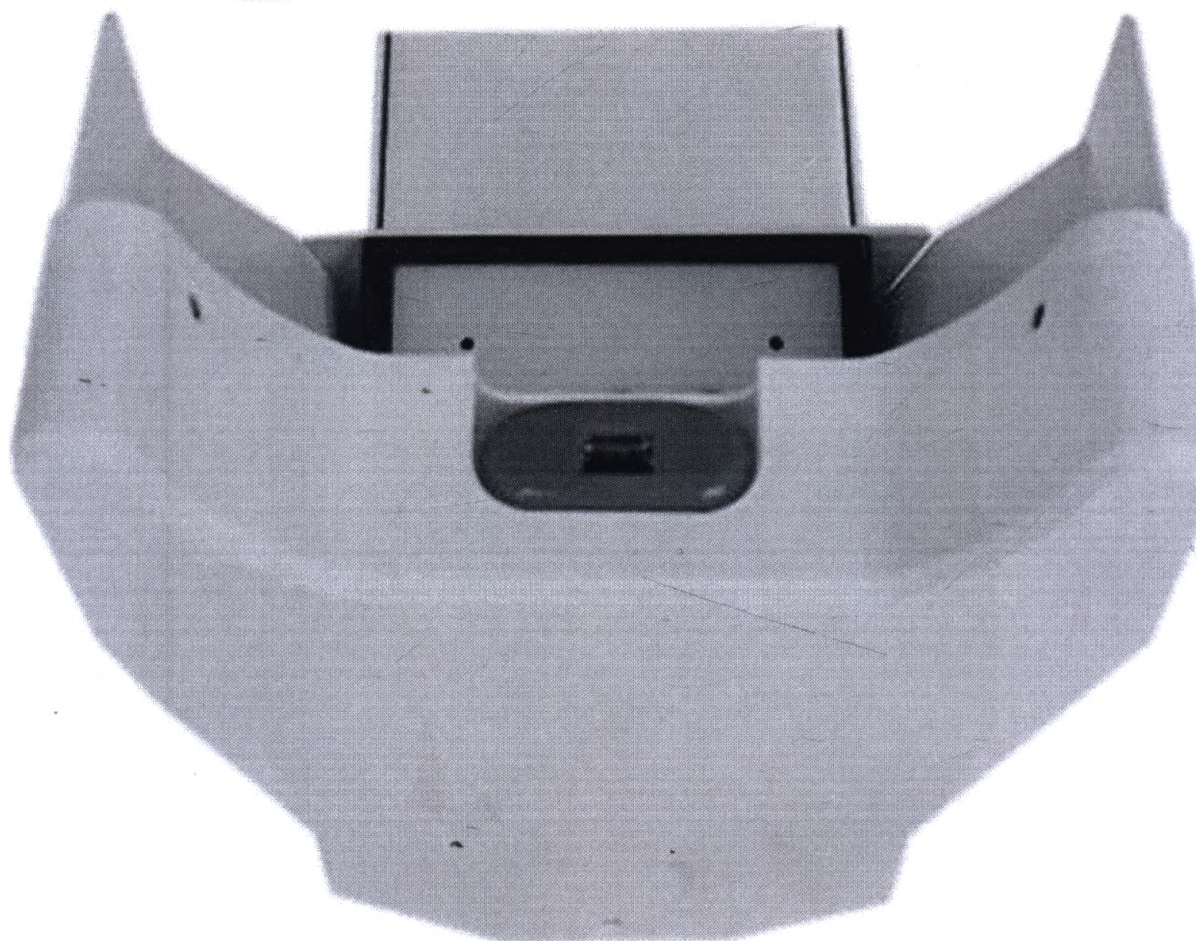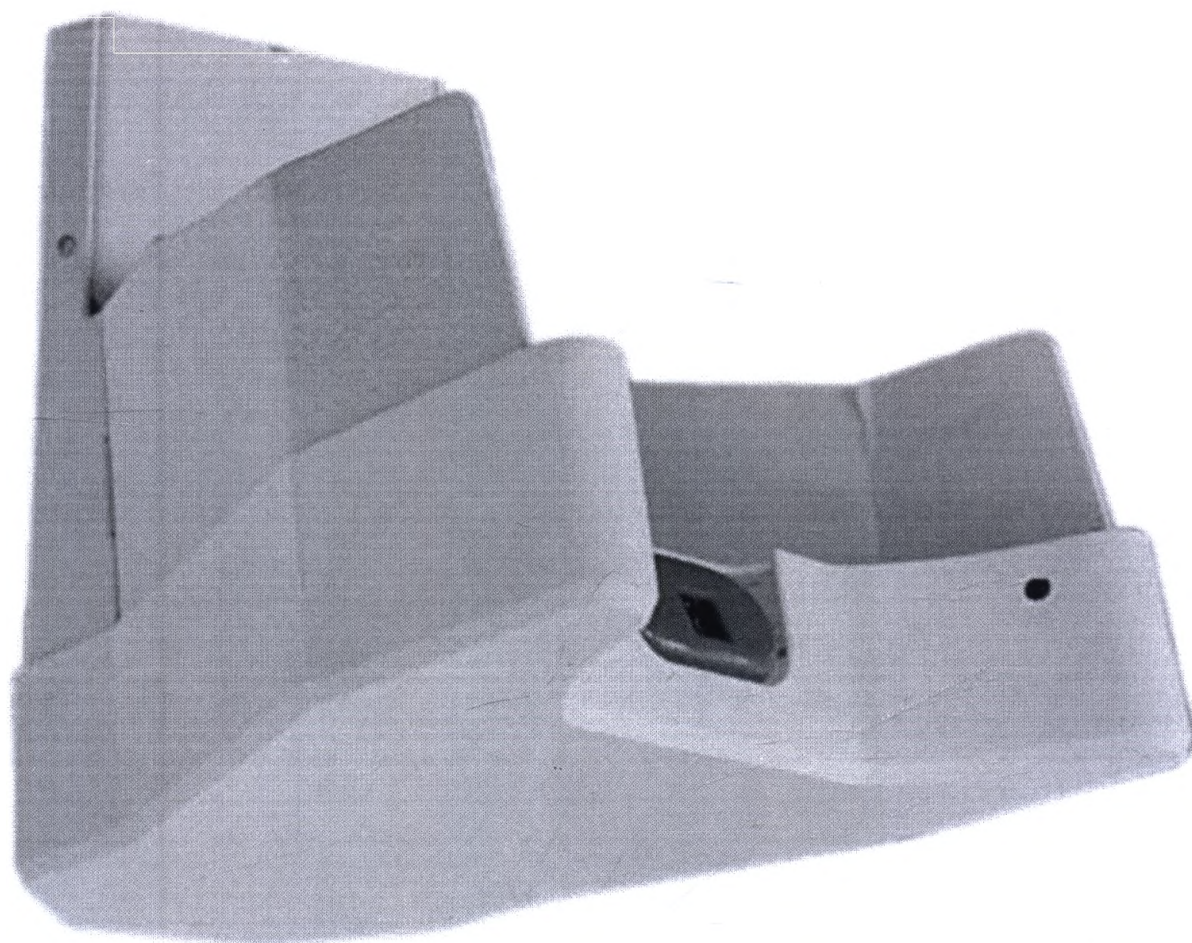



nr




ЗСМО
Электронная
Медицина

Помогите для лучшего функционирования
системы ЦСМО (сервисный центр)
ЗАО ЦРМИ-ОЗ
SN
Производитель: ООО «ВАЗАР»
www.kvzmi.ru
Сделано в России 2022

Бесконтактный инфракрасный термометр Ветсом, модели JXB-183, производитель «Джинхинбао Электроник Ко, Лтд», Китай, РУ РЗН 2013/737.

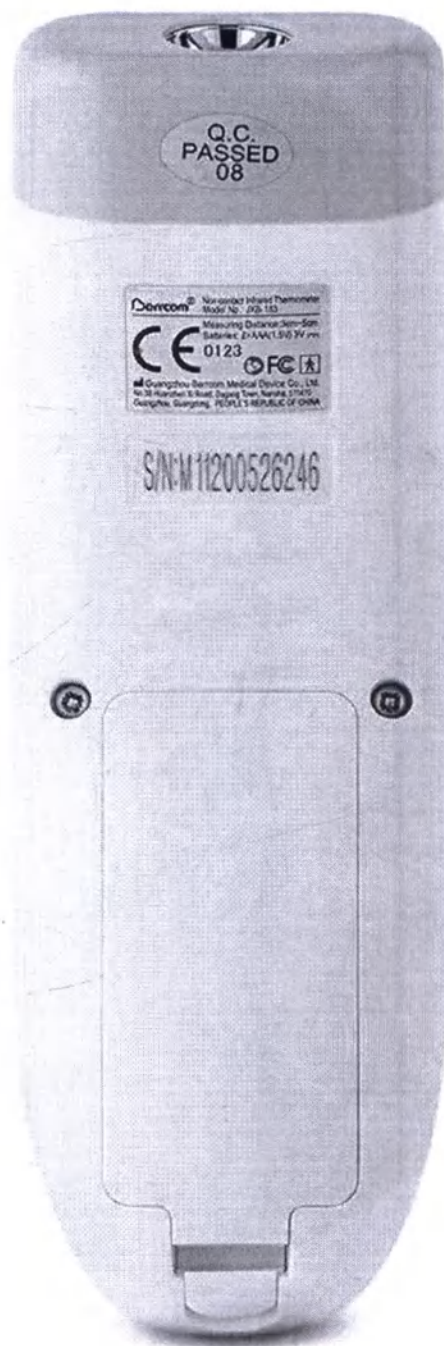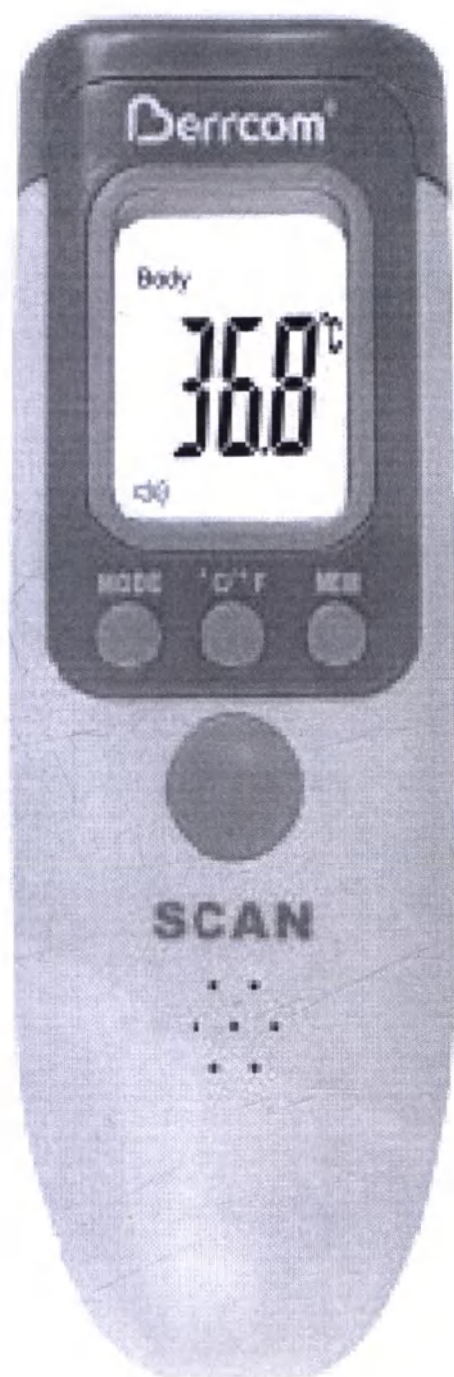

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический цифровой, модели: TM-2655P, «ЭЙ энд ДИ Компани, Лимитед», Япония, РУ № РЗН 2013/283.

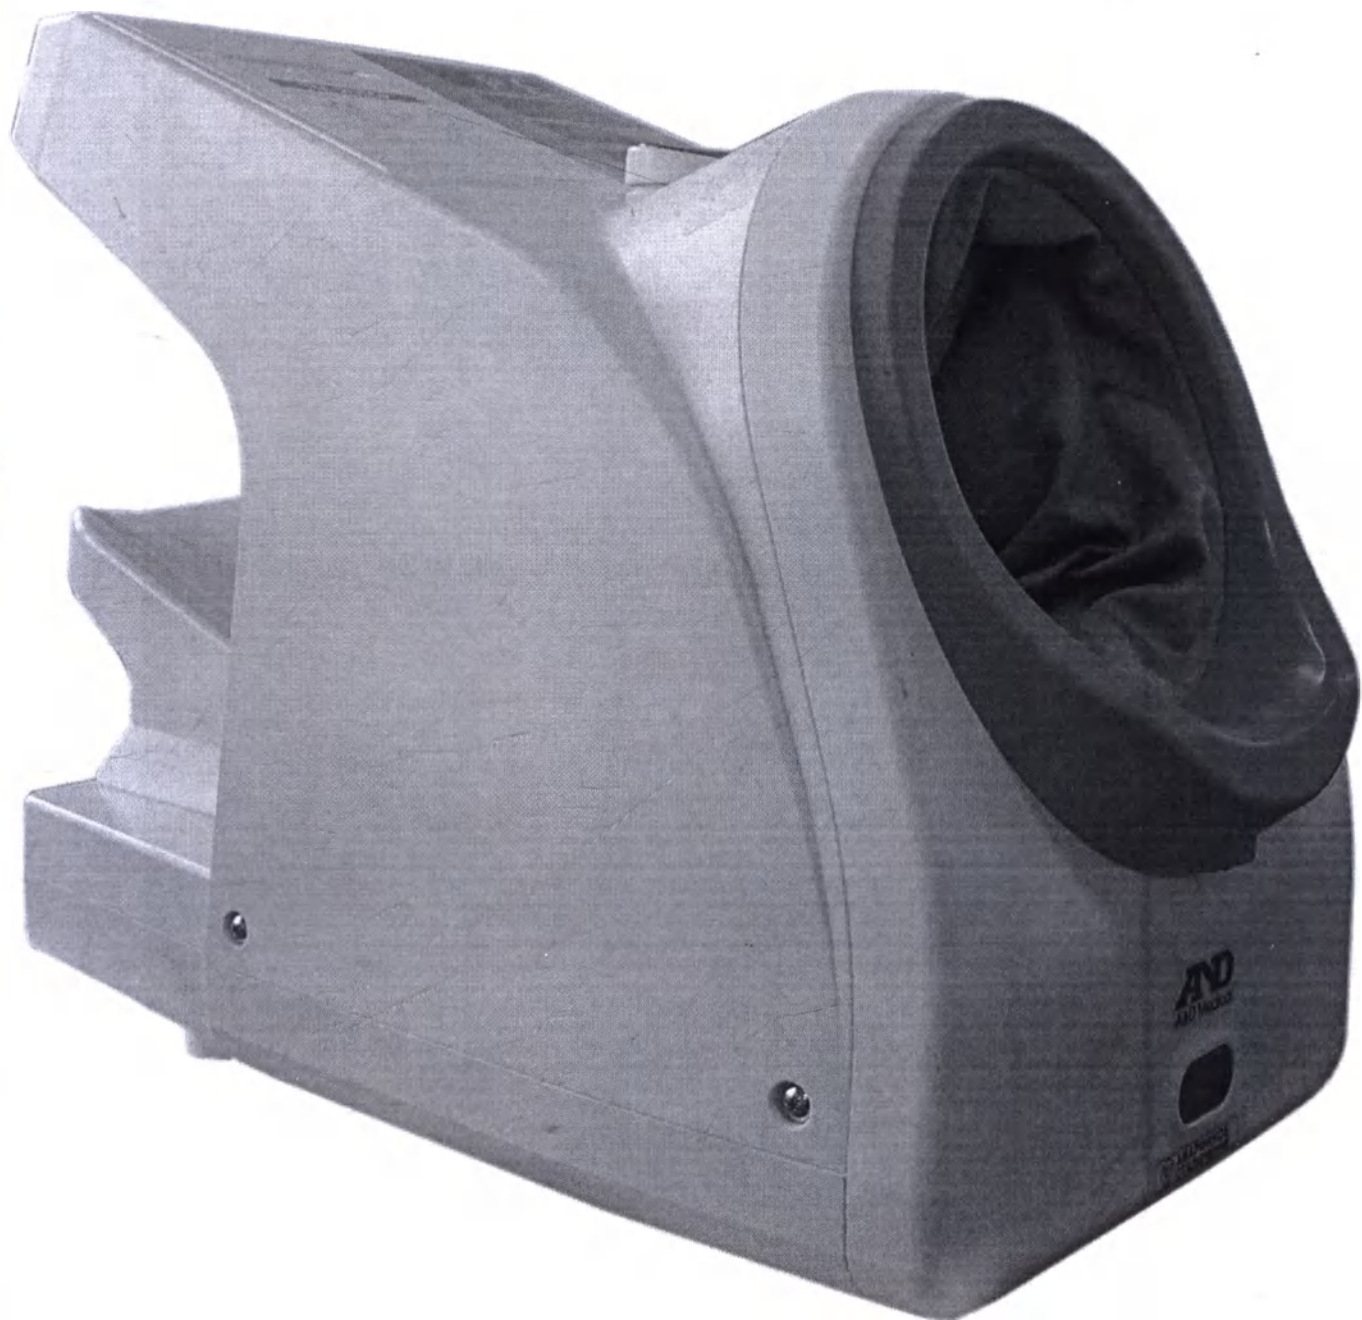




Антивандальное кресло




Считыватель карт

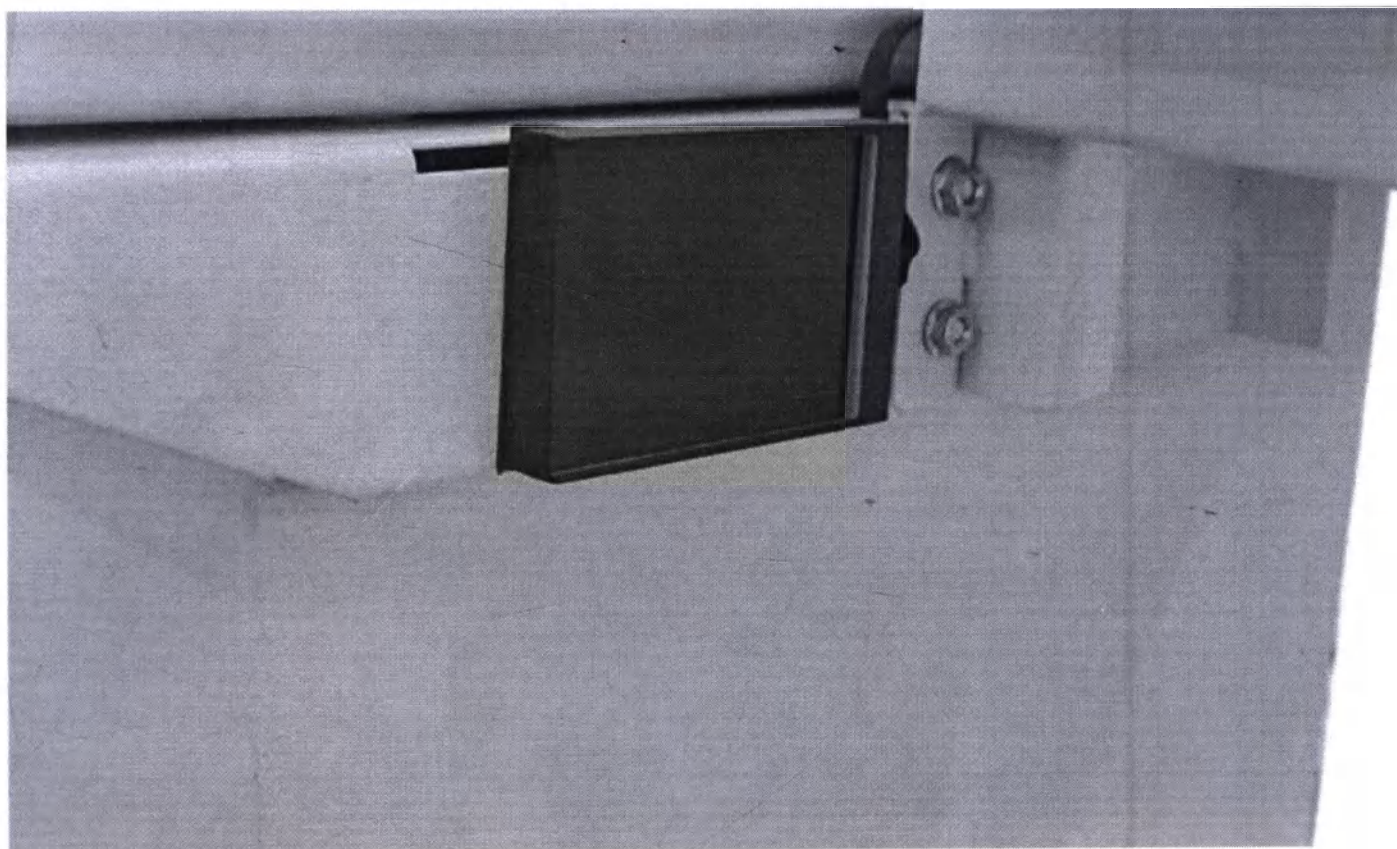

USB WEB Камера



Монитор с сенсорным экраном.

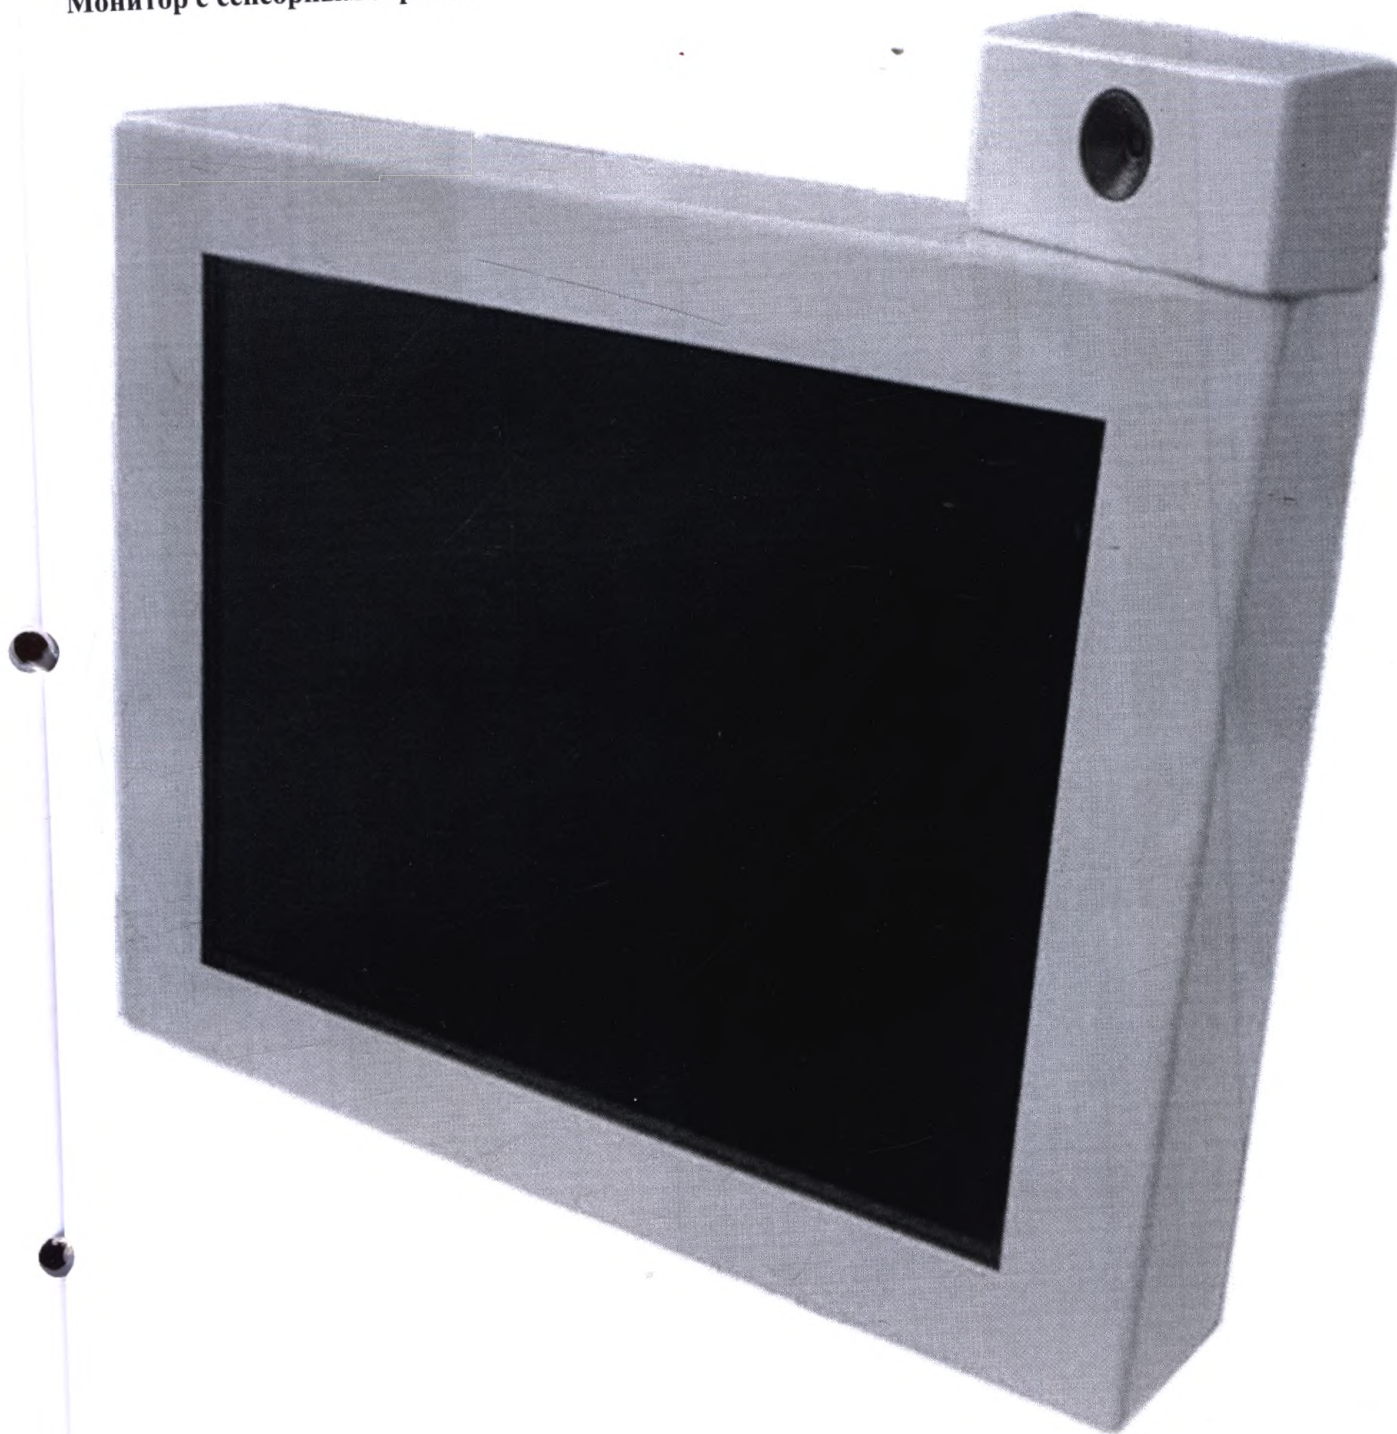

Программное обеспечение "ЭСМО - электронная система медицинских осмотров".



Фельдшер
Фельдшер
Группа: **PMB - Server**
Все терминалы

Начало смены:
11.11.2016 11:55

PMB

Пупиллометрия

Сотрудники

Отчёты

Документы

Настройки

МОНИТОРИНГ

Рабочее место врача

Провести вручную

Терминалы

Журнал МО

Рабочее место врача

ВРЕМЯ НАЧАЛА СМЕНЫ	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СМЕНЫ	ЧИСЛО СОТРУДНИКОВ	ОЖИДАЕТСЯ НА ПРОВЕРКУ	ПРОЙДЕНО МО
11.11.2016 11:55	21:57	3	0	2

ФИО:

Пропуск:

Подразделение:

Все

Допуск к смене:

- ☐ Разрешен
☐ Запрещен
☐ Уклонился

Причина отказа:

- ☐ Алкоголь
☐ Давление

- ☐ Пульс
☐ Жалобы

Показывать:

- ☐ Ожидается на проверку
☒ Текущая смена

Применить

Журнал МО

Режим: **Дежурный фельдшер, МО с начала смены (с 11.11.2016 11:55)**

Группа терминалов: **PMB - Server Все терминалы**

1 ... 50 из 184

№	Дата/время	Терминал	Тип контроля	ФИО сотрудника	Фото	Проверка
50						

Макеты маркировки

ЭСМО

Электронная система
медицинских осмотров

Комплекс аппаратно-программный
«ЭСМО - Электронная система медицинских
осмотров» ТУ 26.60.12-001-29448112-2016
КВЗР.192850.001-03

SN 030220100

МЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА I



Напряжение питания: $\sim 220 \pm 10\%$ В, 50Гц

Потребляемая мощность: не более 150 Вт

IP20

Производитель: ООО «КВАЗАР»

www.kvzrm.ru

Сделано в России



08.2022

ЭСМО

Электронная система
медицинских осмотров

Комплекс аппаратно-программный
«ЭСМО - Электронная система медицинских
осмотров» ТУ 26.60.12-001-29448112-2016
КВЗР.192850.001-02

SN 020220010

МЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА I



Напряжение питания: $\sim 220 \pm 10\%$ В, 50Гц

Потребляемая мощность: не более 150 Вт

IP20

Производитель: ООО «КВАЗАР»


www.kvzrm.ru

Сделано в России



08.2022

Фото в упаковке

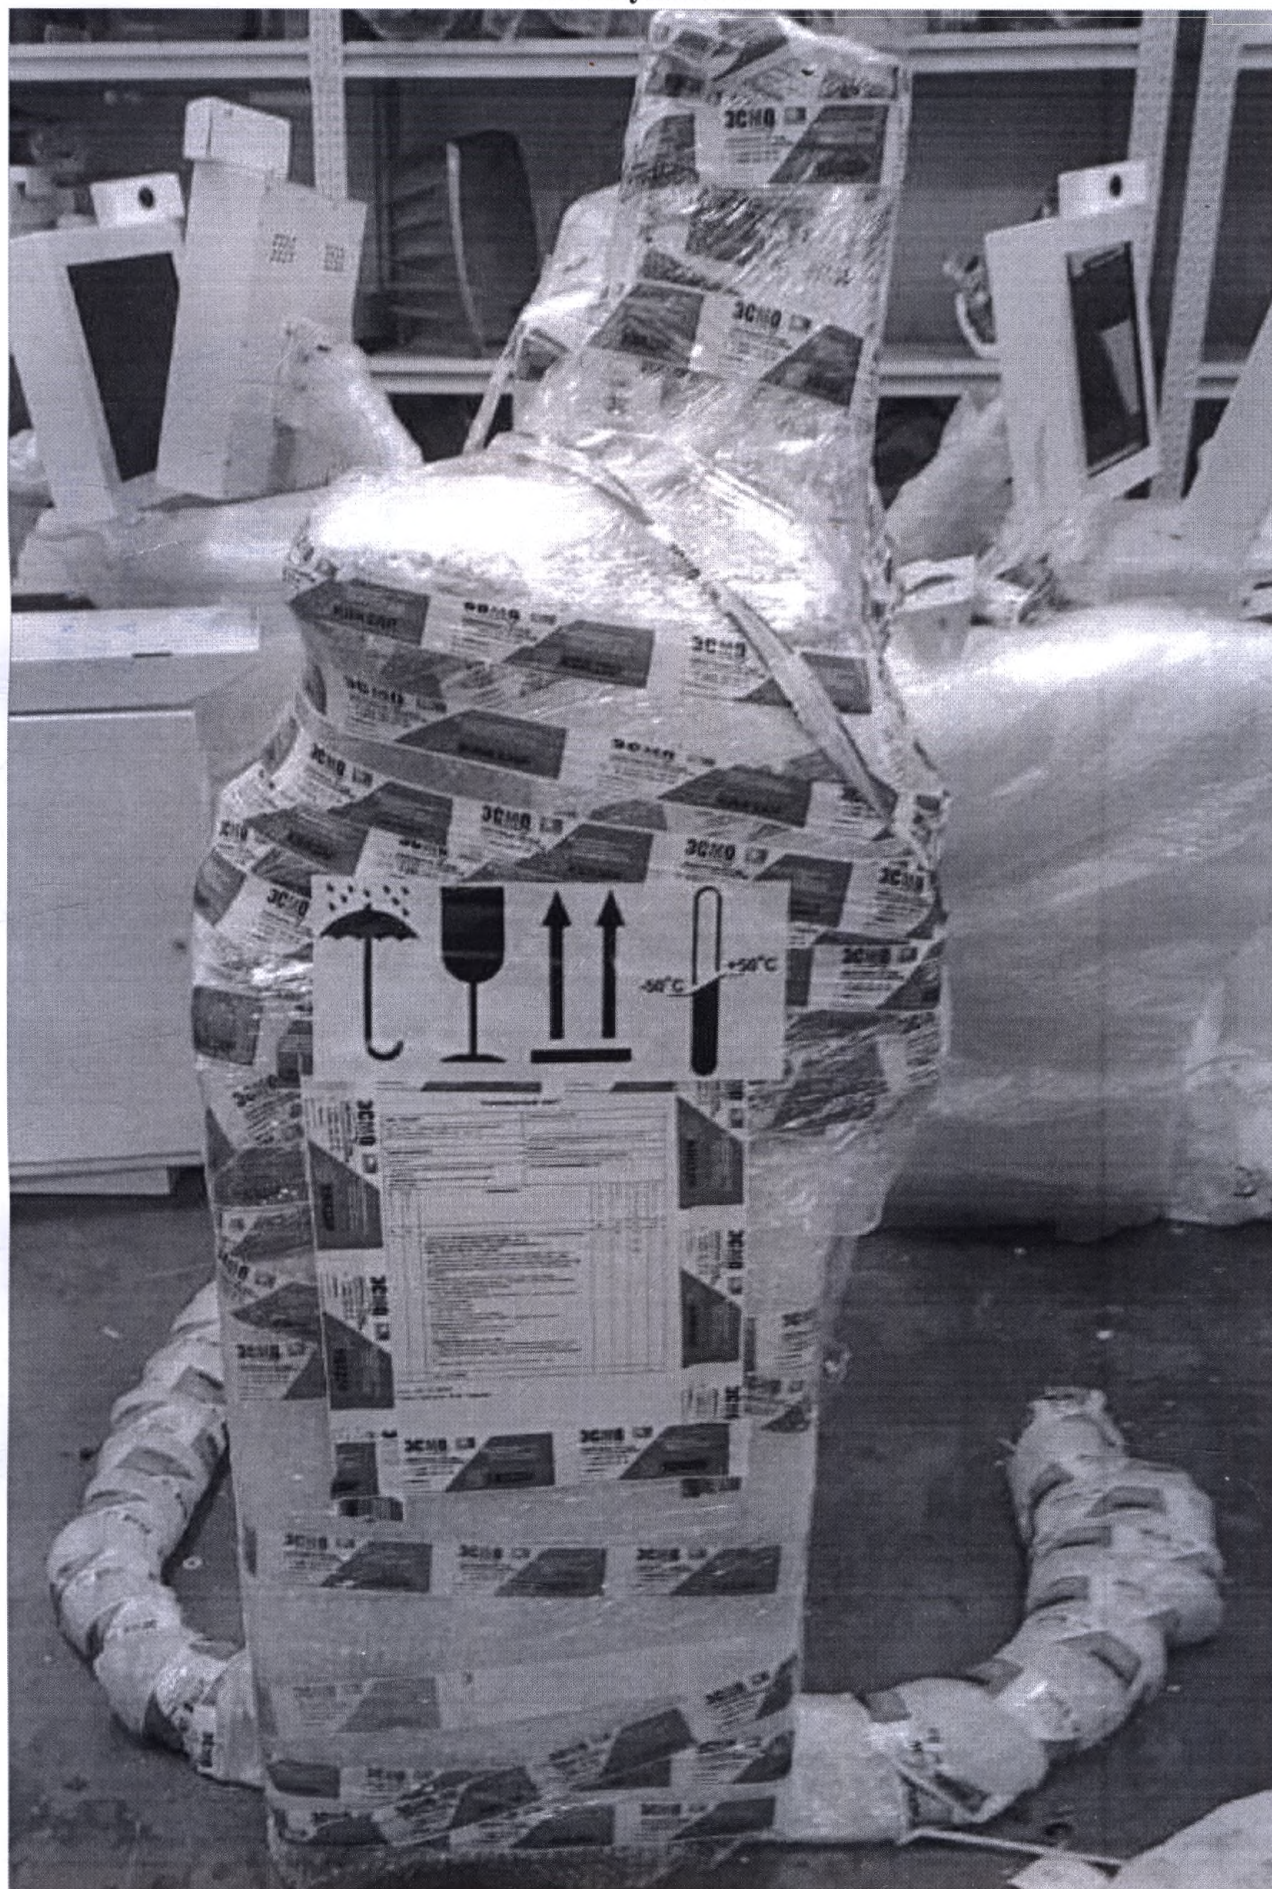

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на 24
двадцати четырех листах

15.05.2023

