

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL[®]X1 к генератору
электрохирургическому, ультразвуковому G11

Старший специалист
по регистрации и сертификации
ООО «Джонсон & Джонсон»
_____ Трафимова Е.Н.





Рис. 1 - Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 25 см, с инструкцией по применению. Вторичная упаковка

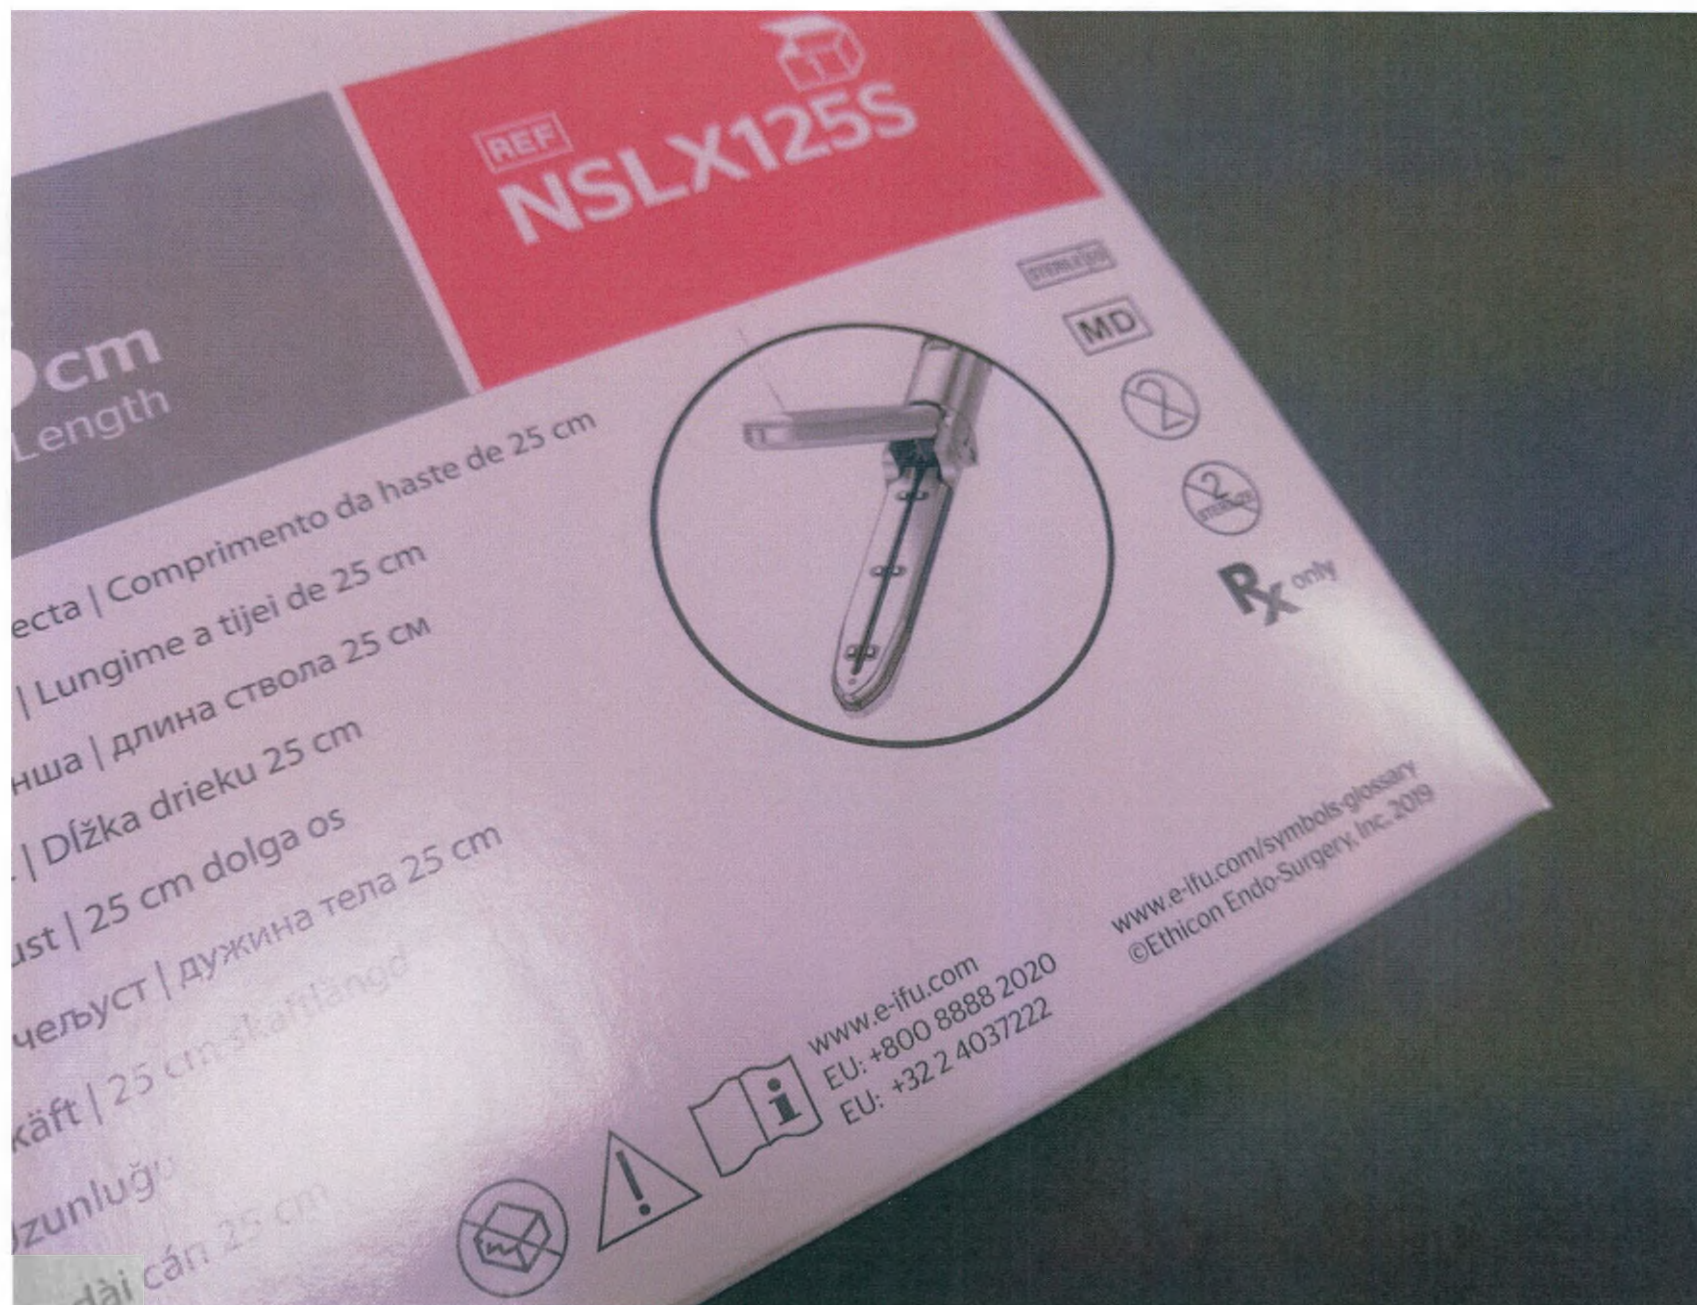


Рис. 2 - Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 25 см, с инструкцией по применению. Маркировка на вторичной упаковке



Рис. 3 - Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 25 см, с инструкцией по применению. Маркировка на вторичной упаковке

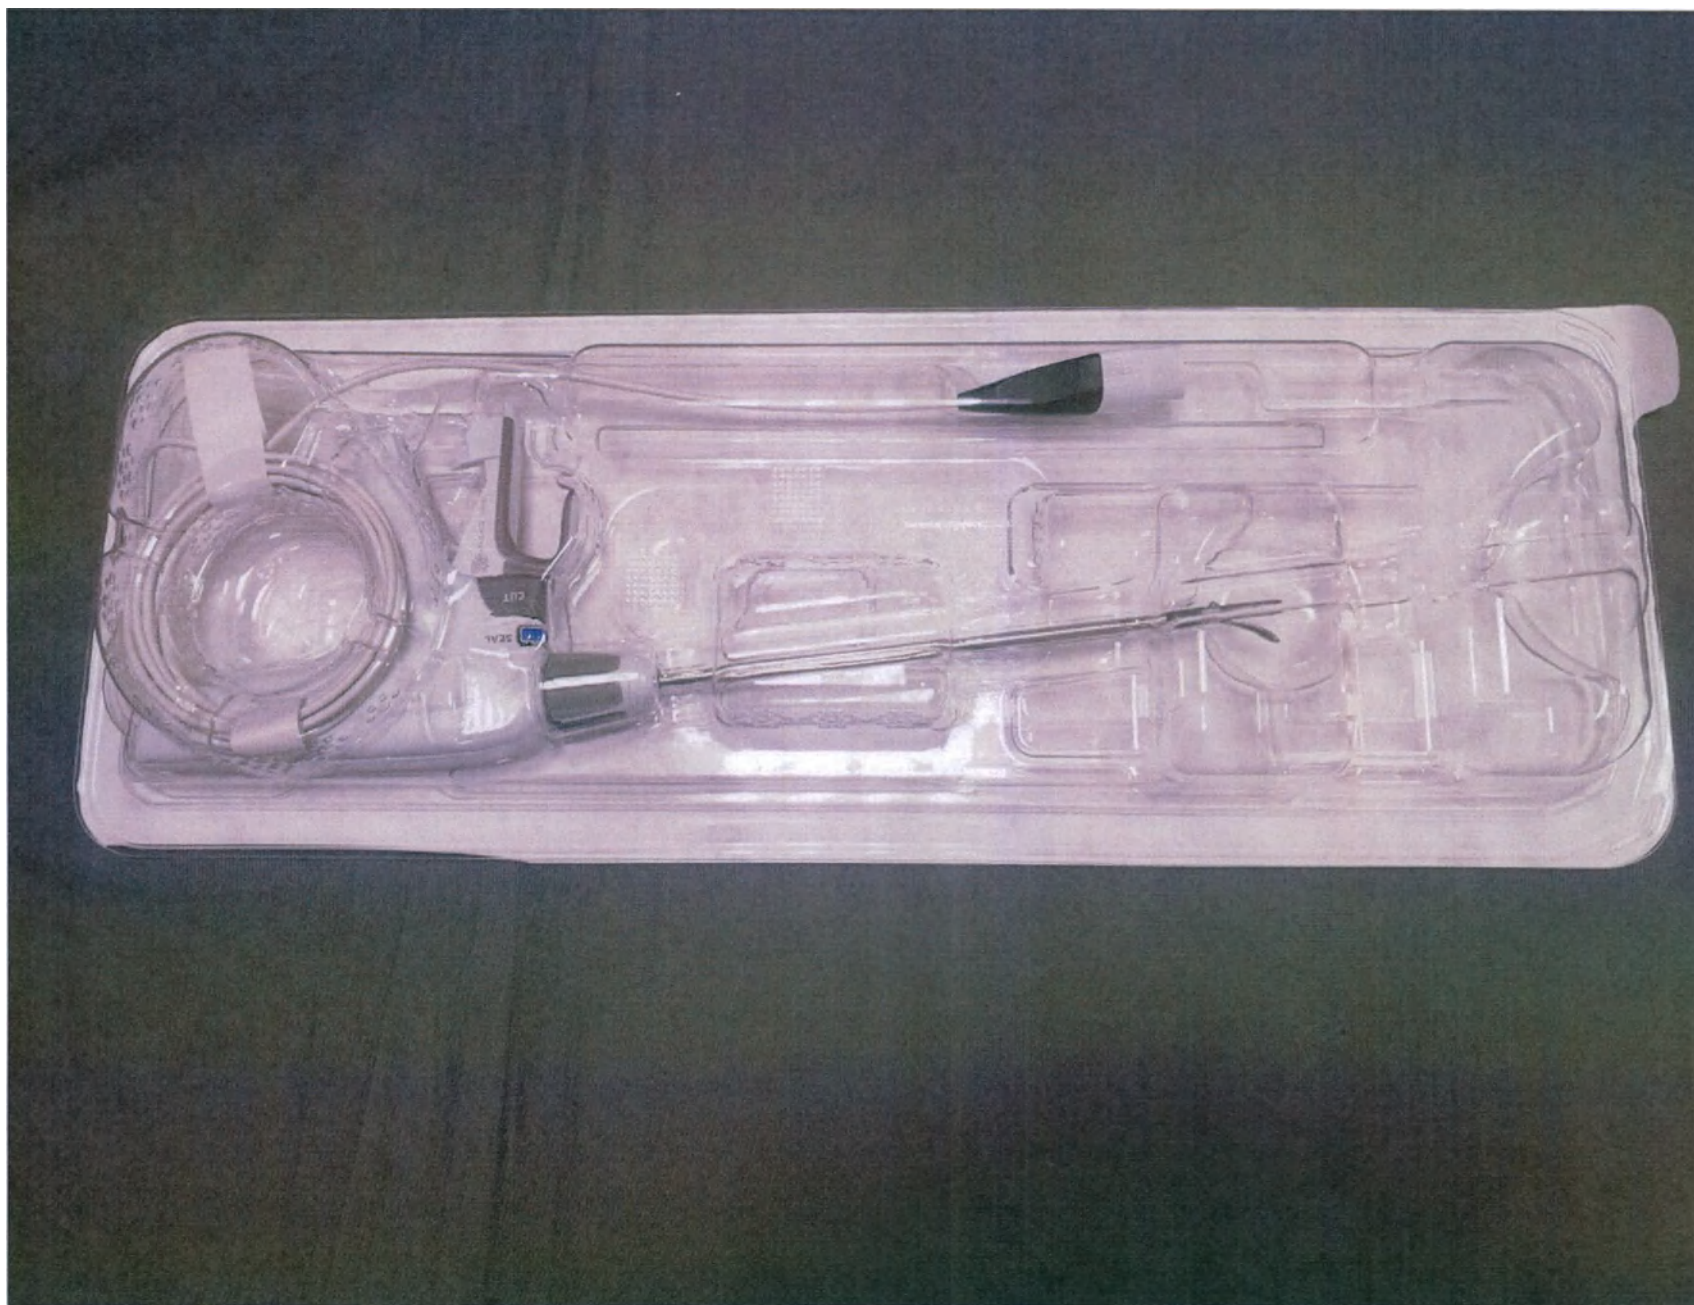


Рис. 4 – Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 25 см, с инструкцией по применению. Стерильная упаковка

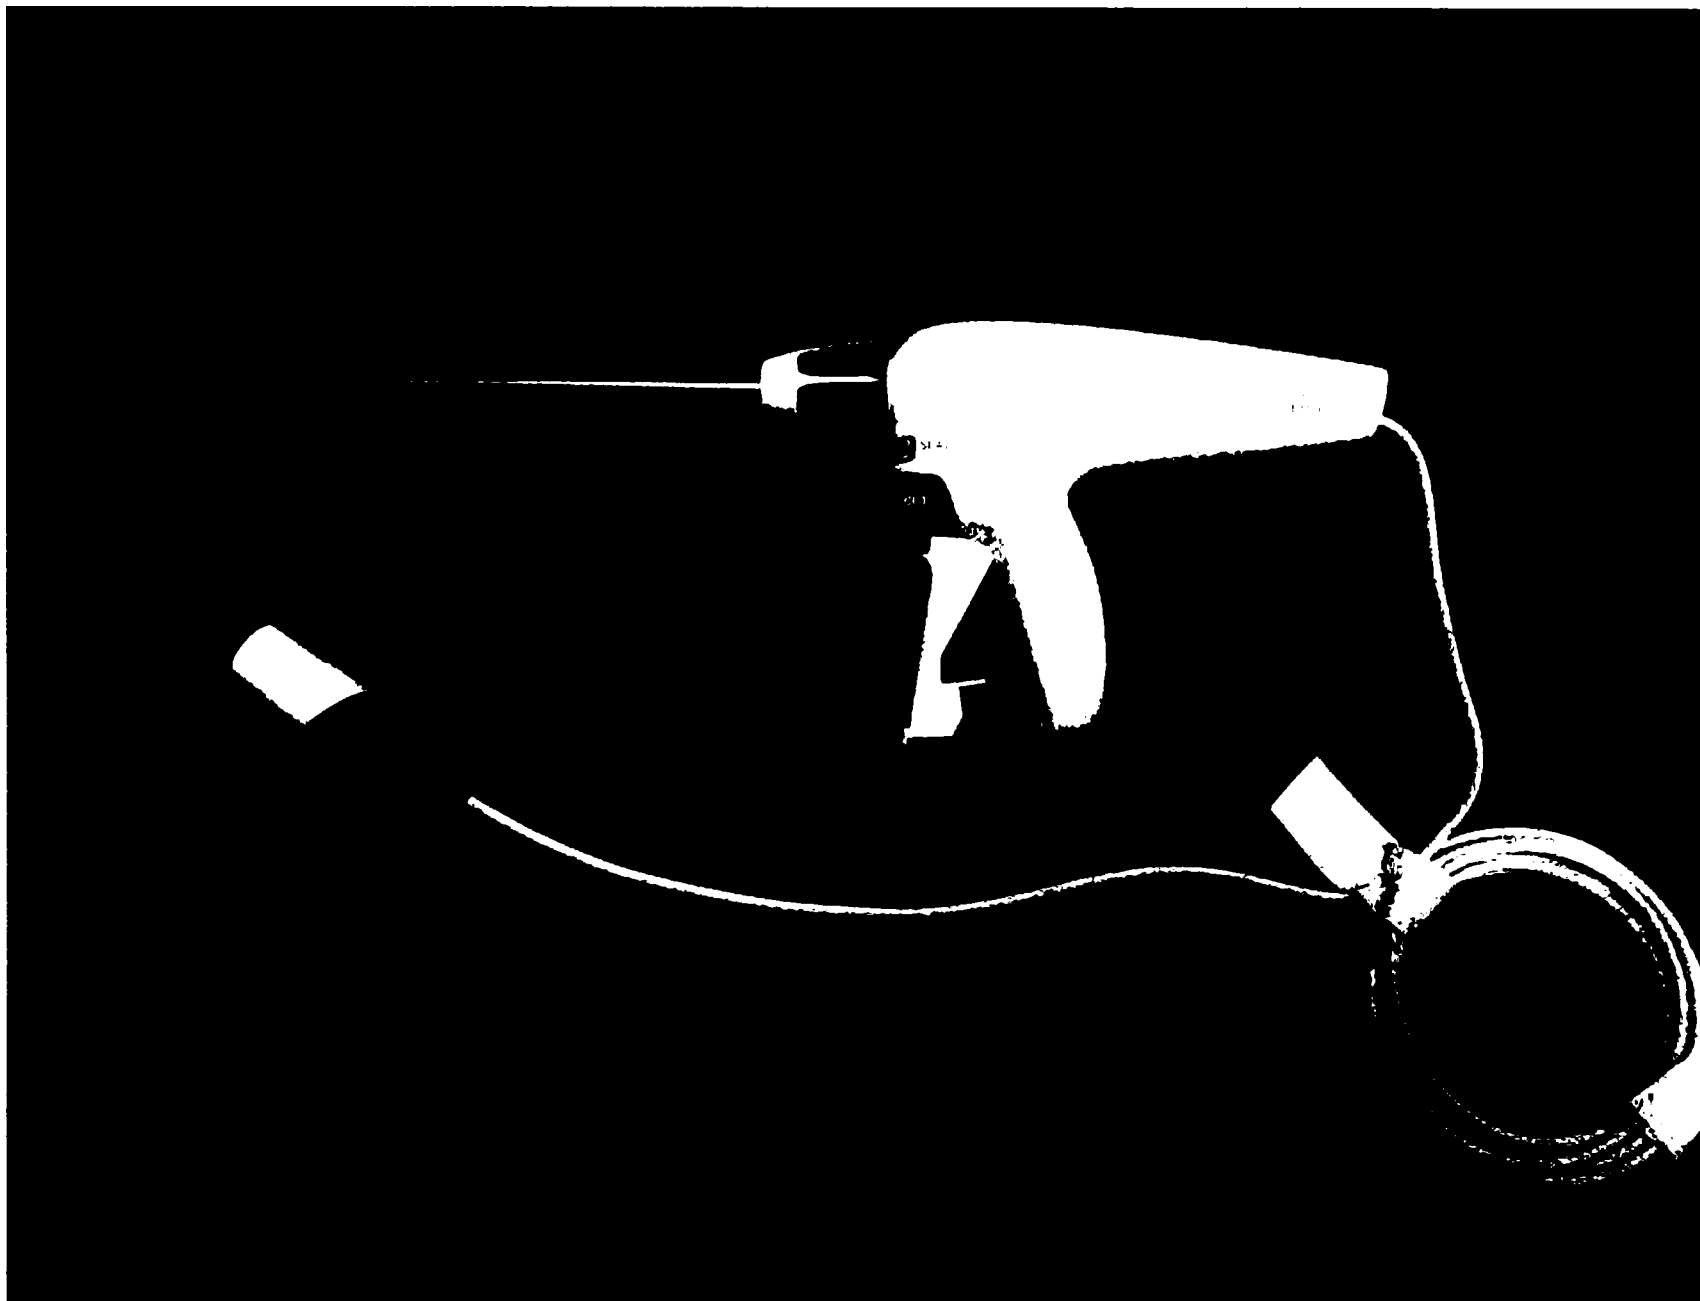


Рис. 6 – Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 25 см, с инструкцией по применению



Рис. 7 – Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 25 см, с инструкцией по применению



Рис. 8 – Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 25 см, с инструкцией по применению

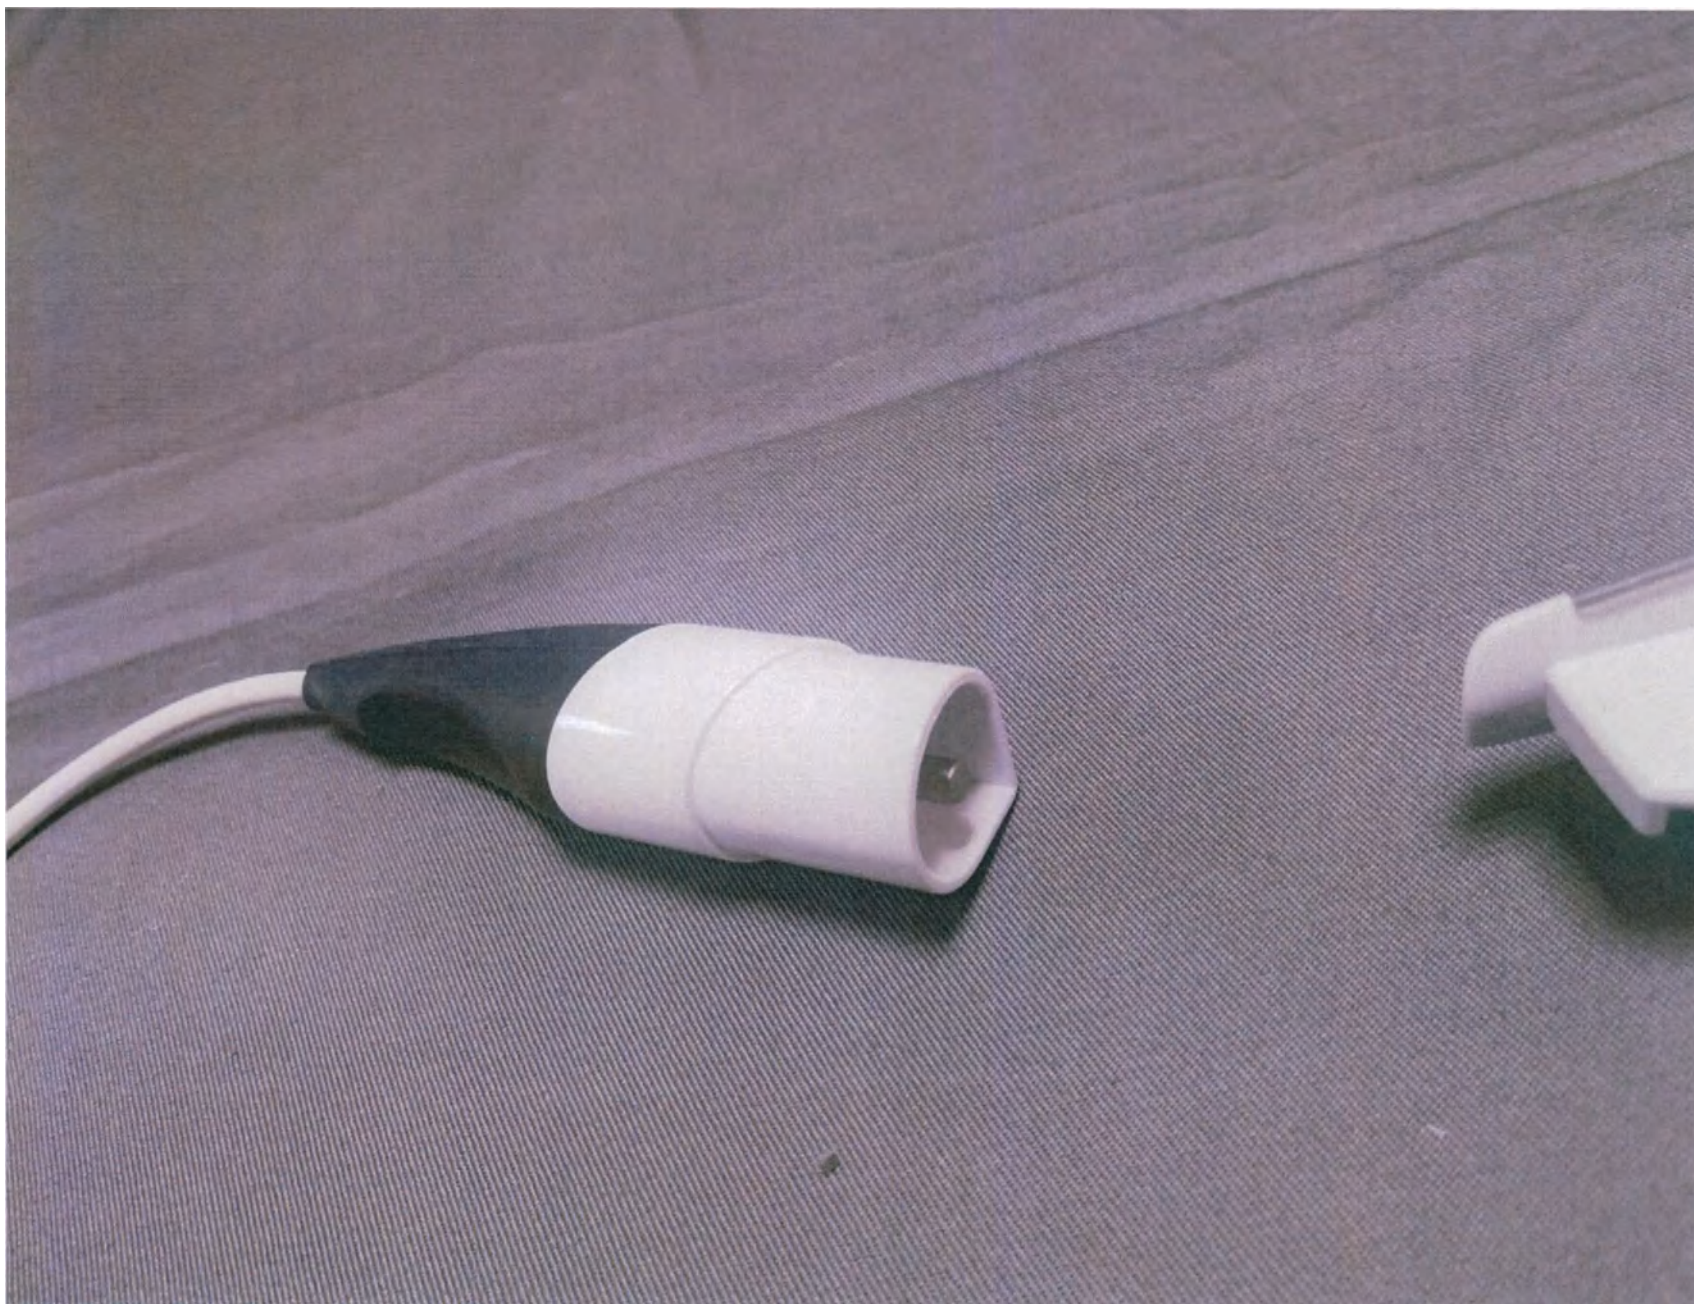


Рис. 9 – Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 25 см, с инструкцией по применению

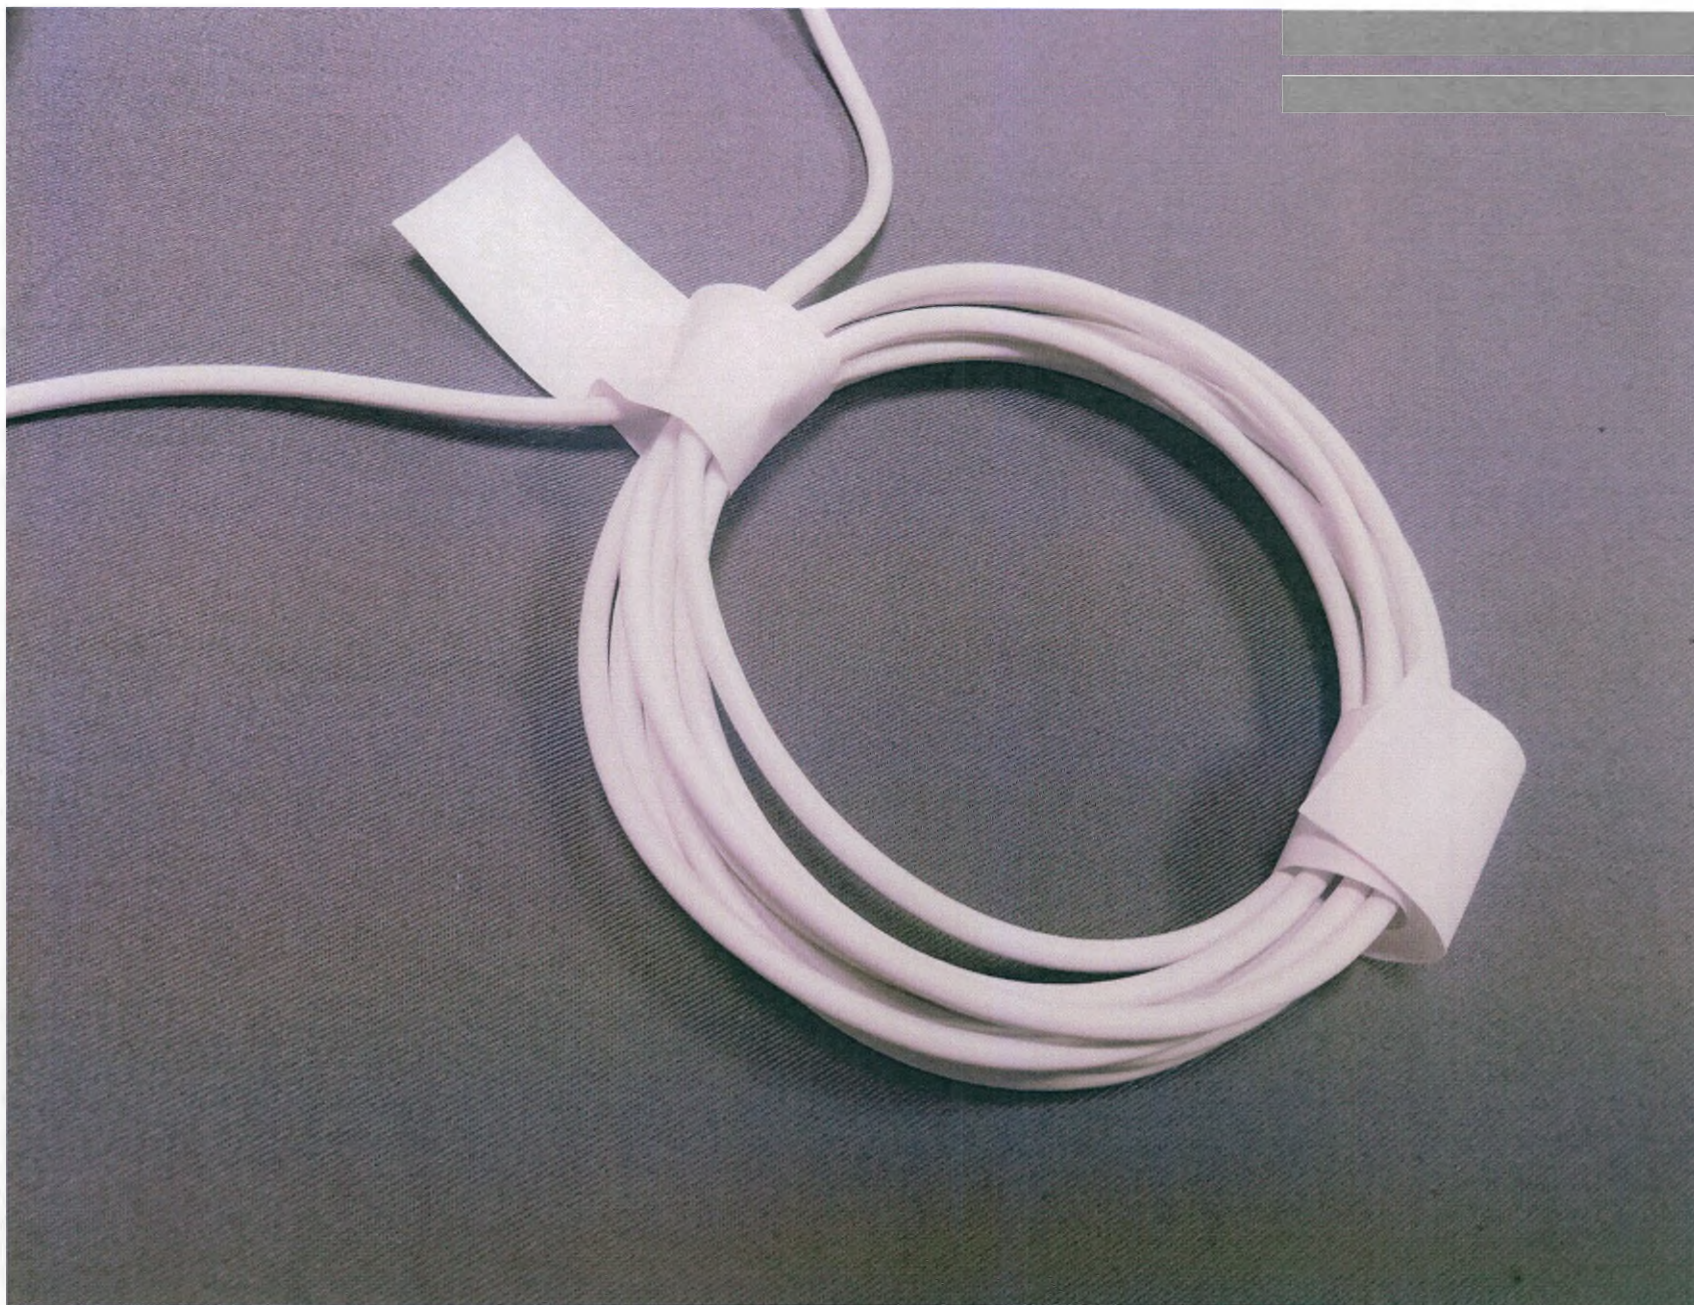


Рис. 10 – Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 25 см, с инструкцией по применению


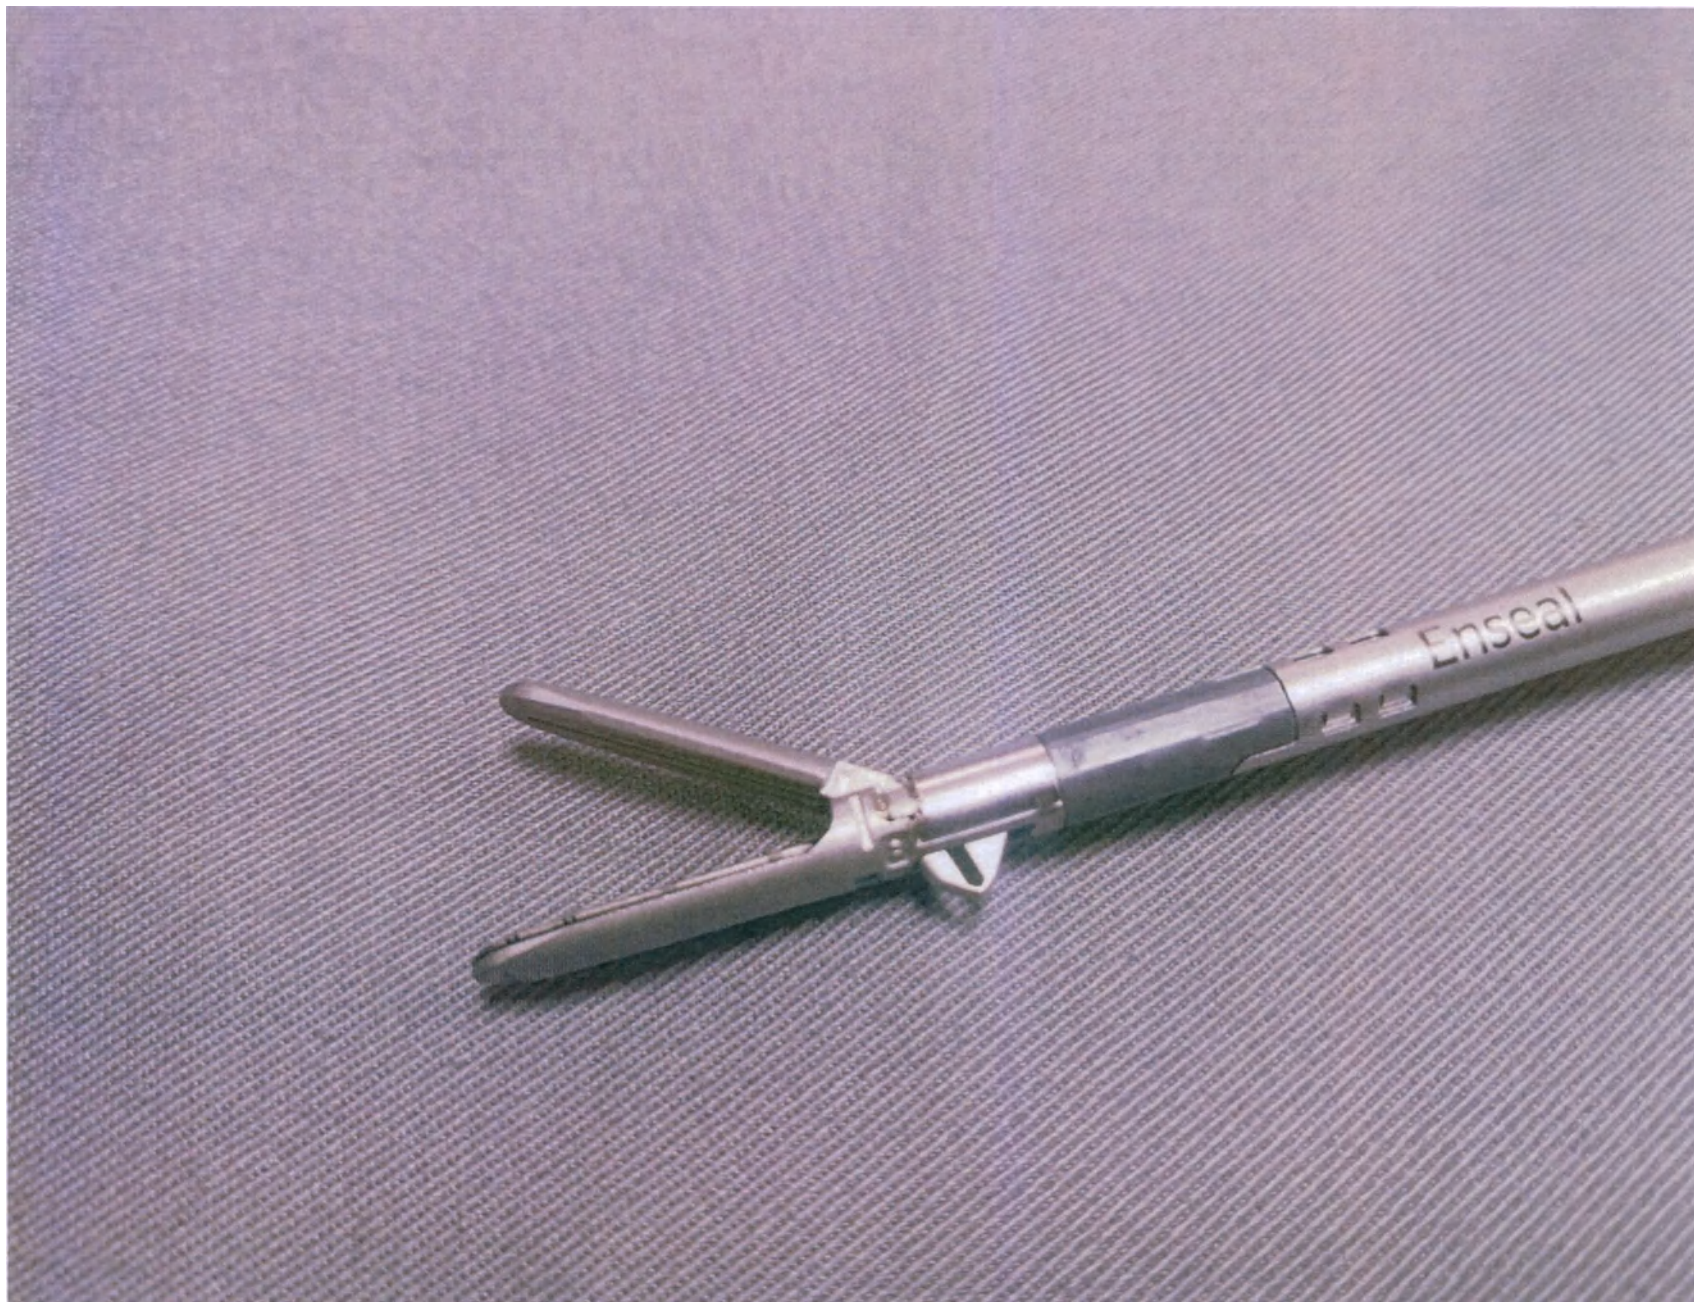


Рис. 11 – Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 25 см, с инструкцией по применению

ETHICON Enseal®

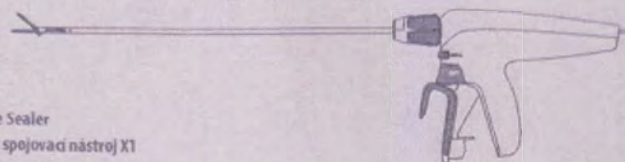

en: X1 Tissue Sealer
 cs: Tkáňový spojovací nástroj X1
 da: X1-vævsforsegler
 de: X1 Versiegelungsinstrument
 el: Στεγνωτικό ιστών X1
 es: Sellador de tejido X1
 fi: X1-kudosfuusiolaitte
 fr: Dispositif de coagulation tissulaire X1
 hu: X1 szövetlezáró
 it: Dispositivo di chiusura tissutale X1
 nl: X1 Weefseldichtend instrument
 pl: Zgrzewarka do tkanek X1
 pt: Dispositivo de selagem de tecidos X1
 sv: X1 tillslutningsinstrument för vävnad
 tr: X1 Doku Kapatıcı
 zh: X1 组织凝固系统刀头
 bg, et, hr, id, it, lv, mk, no, ro, ru, sk, sl, sr, vi: www.e-ifu.com

Please read all information carefully.

Failure to properly follow the instructions may lead to serious surgical consequences.

Important: This package insert is designed to provide instructions for use of the ENSEAL® X1 Tissue Sealer. It is not a reference to surgical techniques.

ETHICON™

PART OF THE JOHNSON & JOHNSON FAMILY OF COMPANIES

Рис. 12 – Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 25 см, с инструкцией по применению



Рис. 13 - Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 37 см, с инструкцией по применению. Вторичная упаковка

straight Jaw

37 cm
Shaft Length

REF 
NSLX137S

pt: Dispositivo de selagem de tecidos X1 ENSEAL® Mandíbula recta | Comprimento da haste de 37 cm

ro: Dispozitiv de sigilare a ţesuturilor ENSEAL® X1 Fălci drepte | Lungimea a gâtului de 37 cm

ru: Коагулятор-диссектор тканей ENSEAL® X1 Прямая бранша | длина ствола 37 см

sk: Nástroj na uzatváranie tkanív ENSEAL® X1 Priama čeľusť | Dĺžka drieku 37 cm

sl: Pripomoček za zatesnitev tkiva ENSEAL® X1 Ravna čeľust | 37 cm dolga os


sr: ENSEAL® X1 instrument za zatvaranje tkiva Prava čeľust | dužina tela 37 cm

sv: ENSEAL® X1 tillslutningsinstrument för vävnad Rak käft | 37 cm skaftlängd

tr: ENSEAL® X1 Doku Kapatıcı Düz Çene | 37 cm Şaft Uzunluğu

vi: Dao hàn mạch ENSEAL® X1 Họng kẹp thẳng | Chiều dài cán 37 cm

zh: ENSEAL® X1 组织凝闭系统刀头 直钳口 | 37 厘米杆身长度

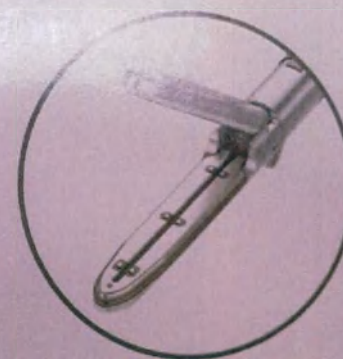

STERILE EO

MD



Rx only



www.eifu.com
EU: +800 8888 2020
EU: +32 2 4037222

www.eifu.com/symbols-glossary
©Ethicon Endo-Surgery, Inc. 2019

Рис. 14 - Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 37 см, с инструкцией по применению. Маркировка на вторичной упаковке



Рис. 15 - Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 37 см, с инструкцией по применению. Маркировка на вторичной упаковке



Рис. 17 – Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 37 см, с инструкцией по применению

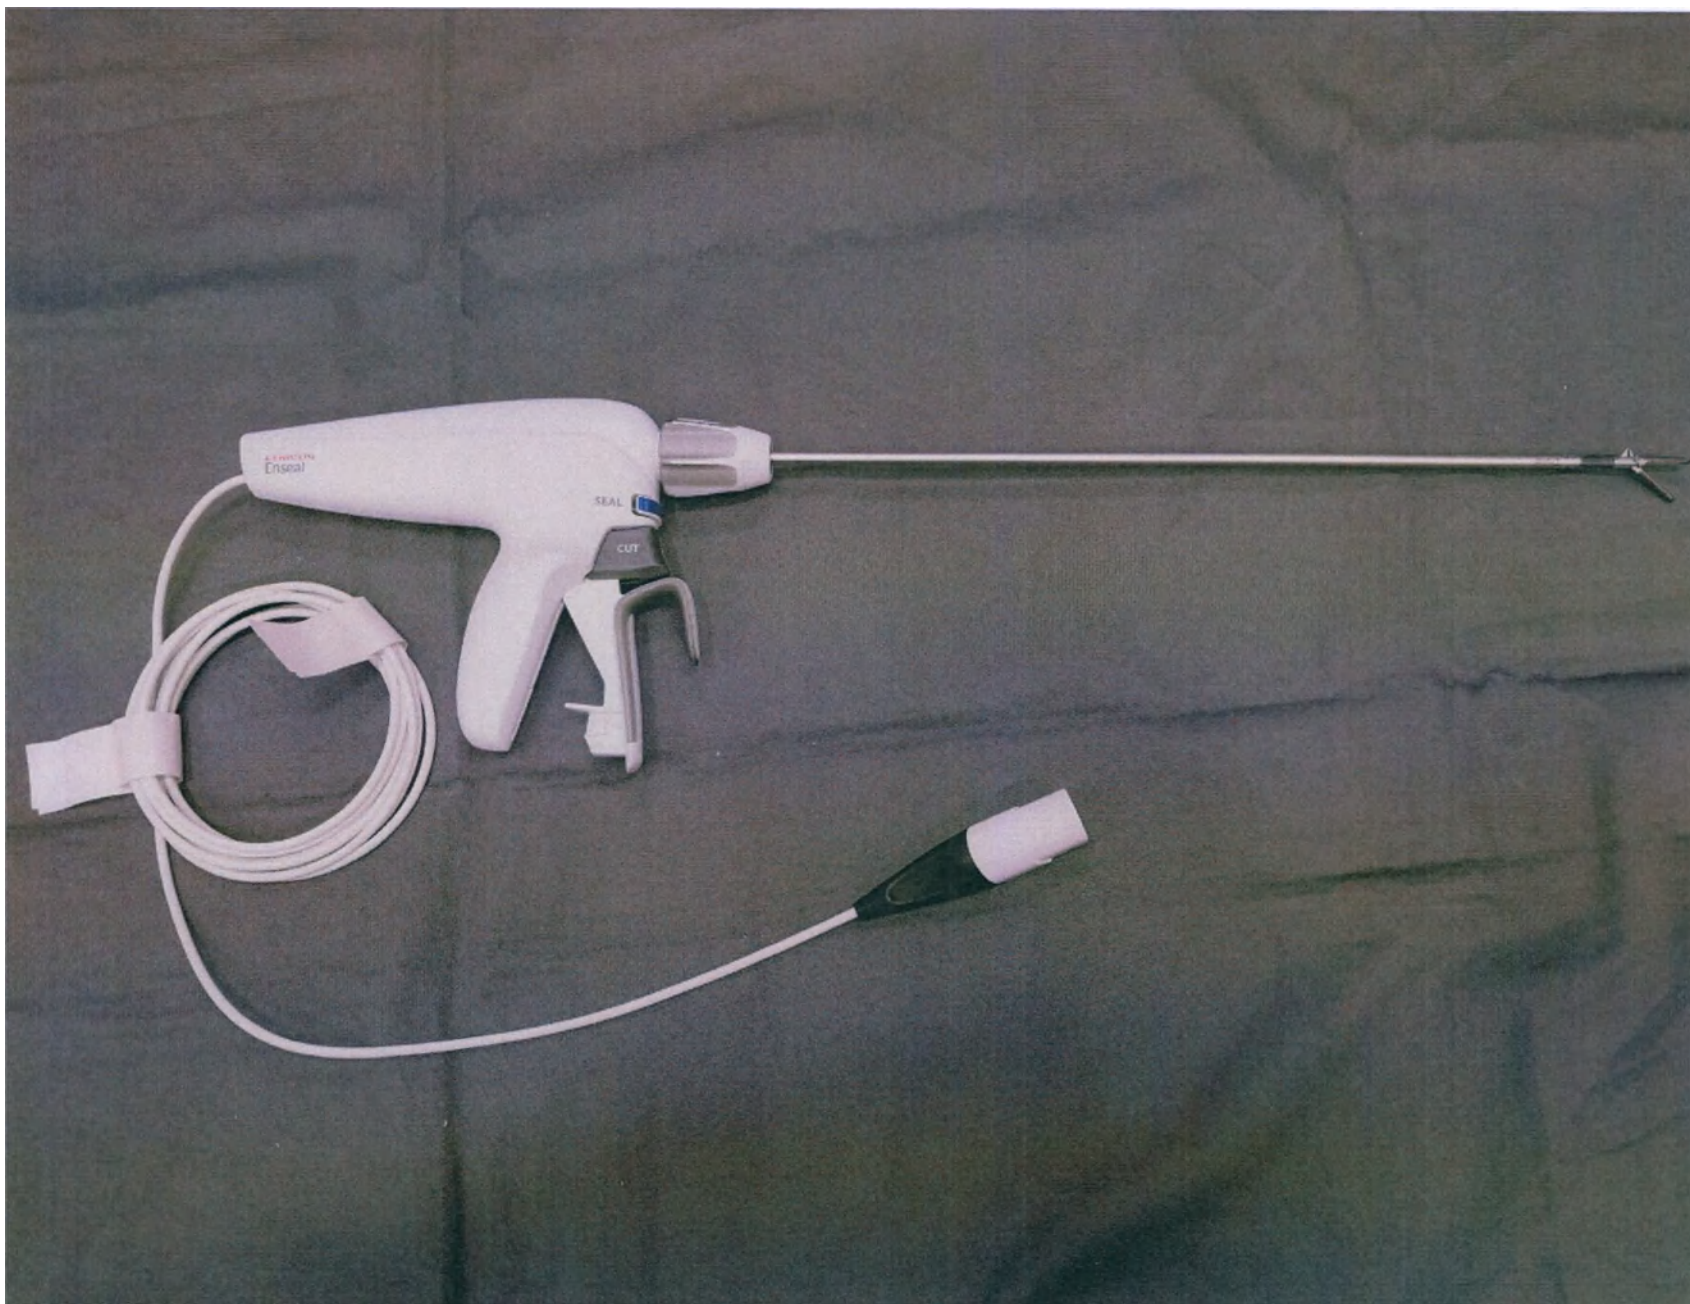


Рис. 18 – Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 37 см, с инструкцией по применению



Рис. 19 – Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 37 см, с инструкцией по применению



Рис. 20 – Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 37 см, с инструкцией по применению

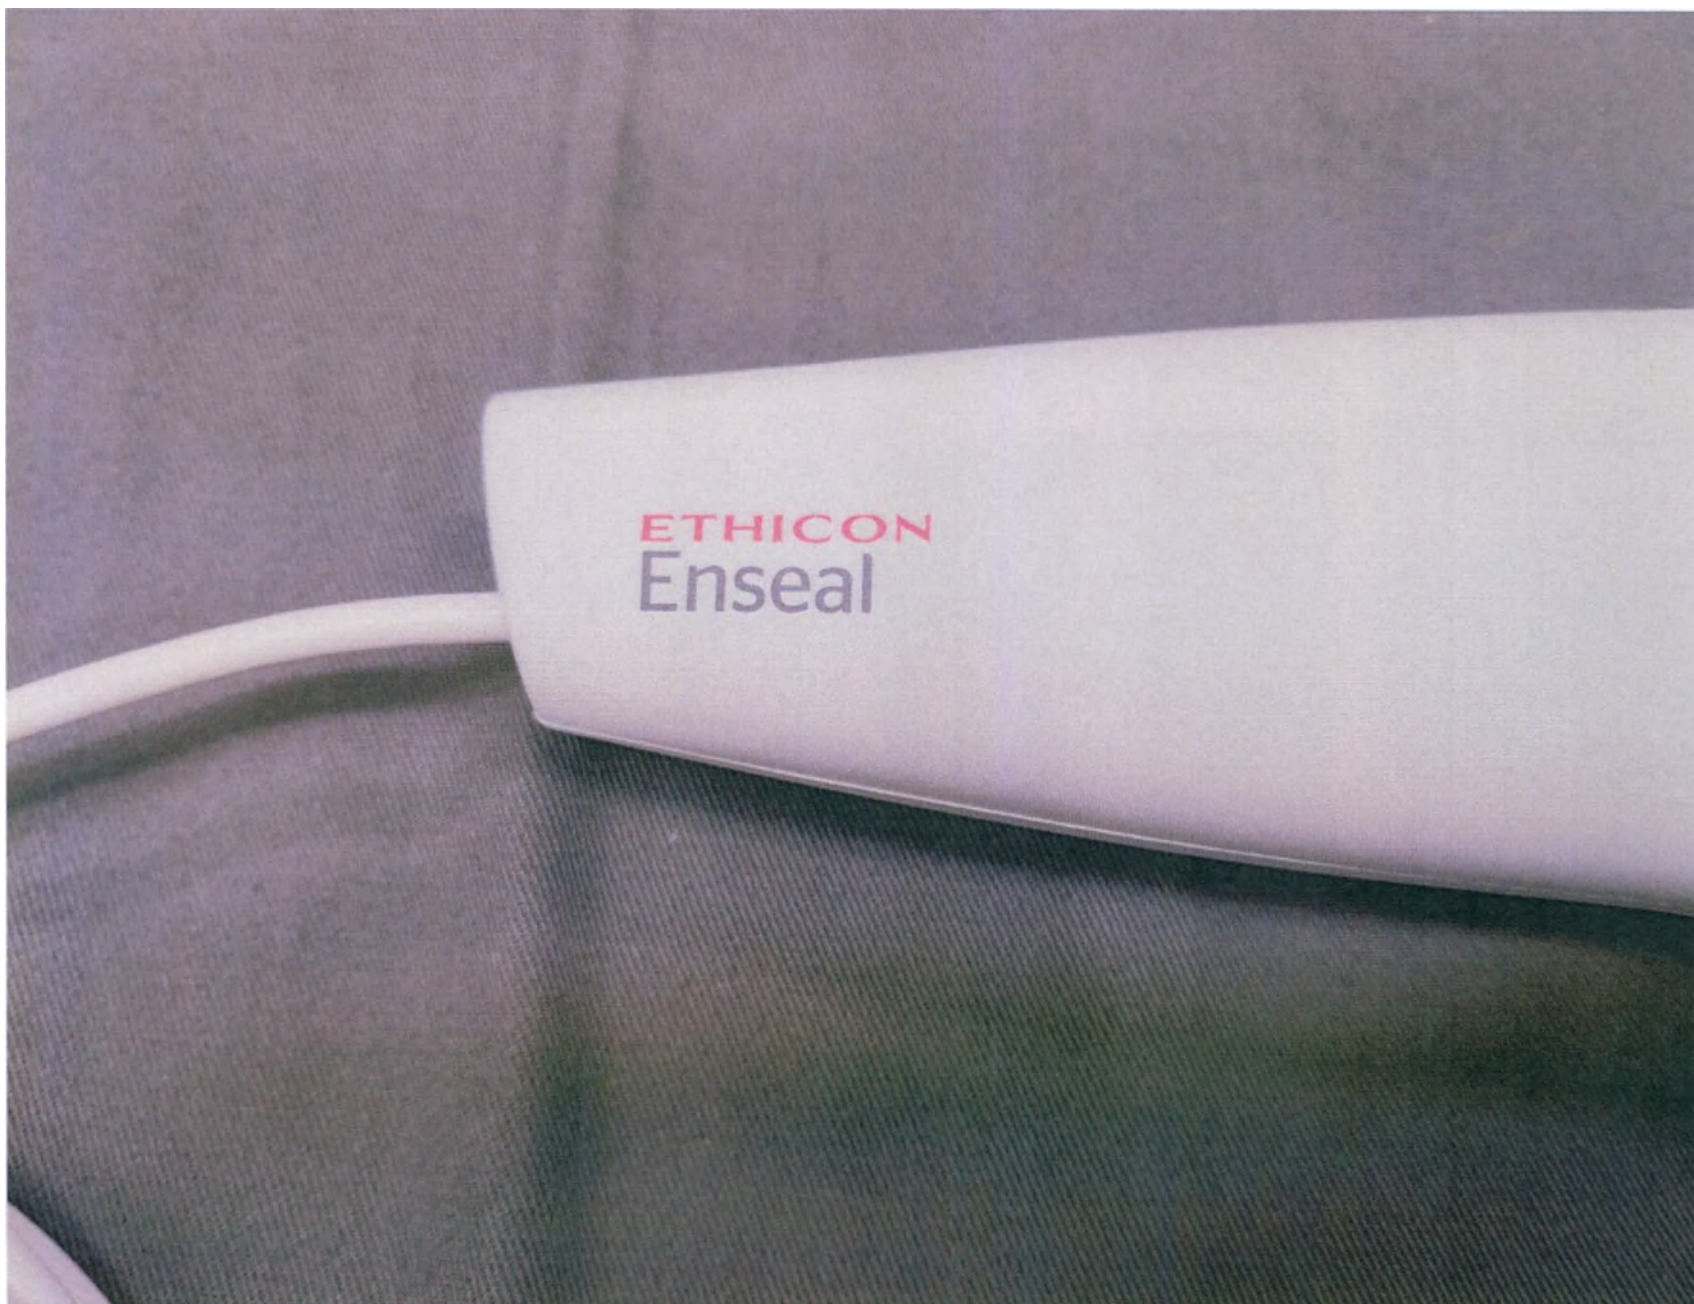


Рис. 21 – Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 37 см, с инструкцией по применению



Рис. 22 – Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 37 см, с инструкцией по применению

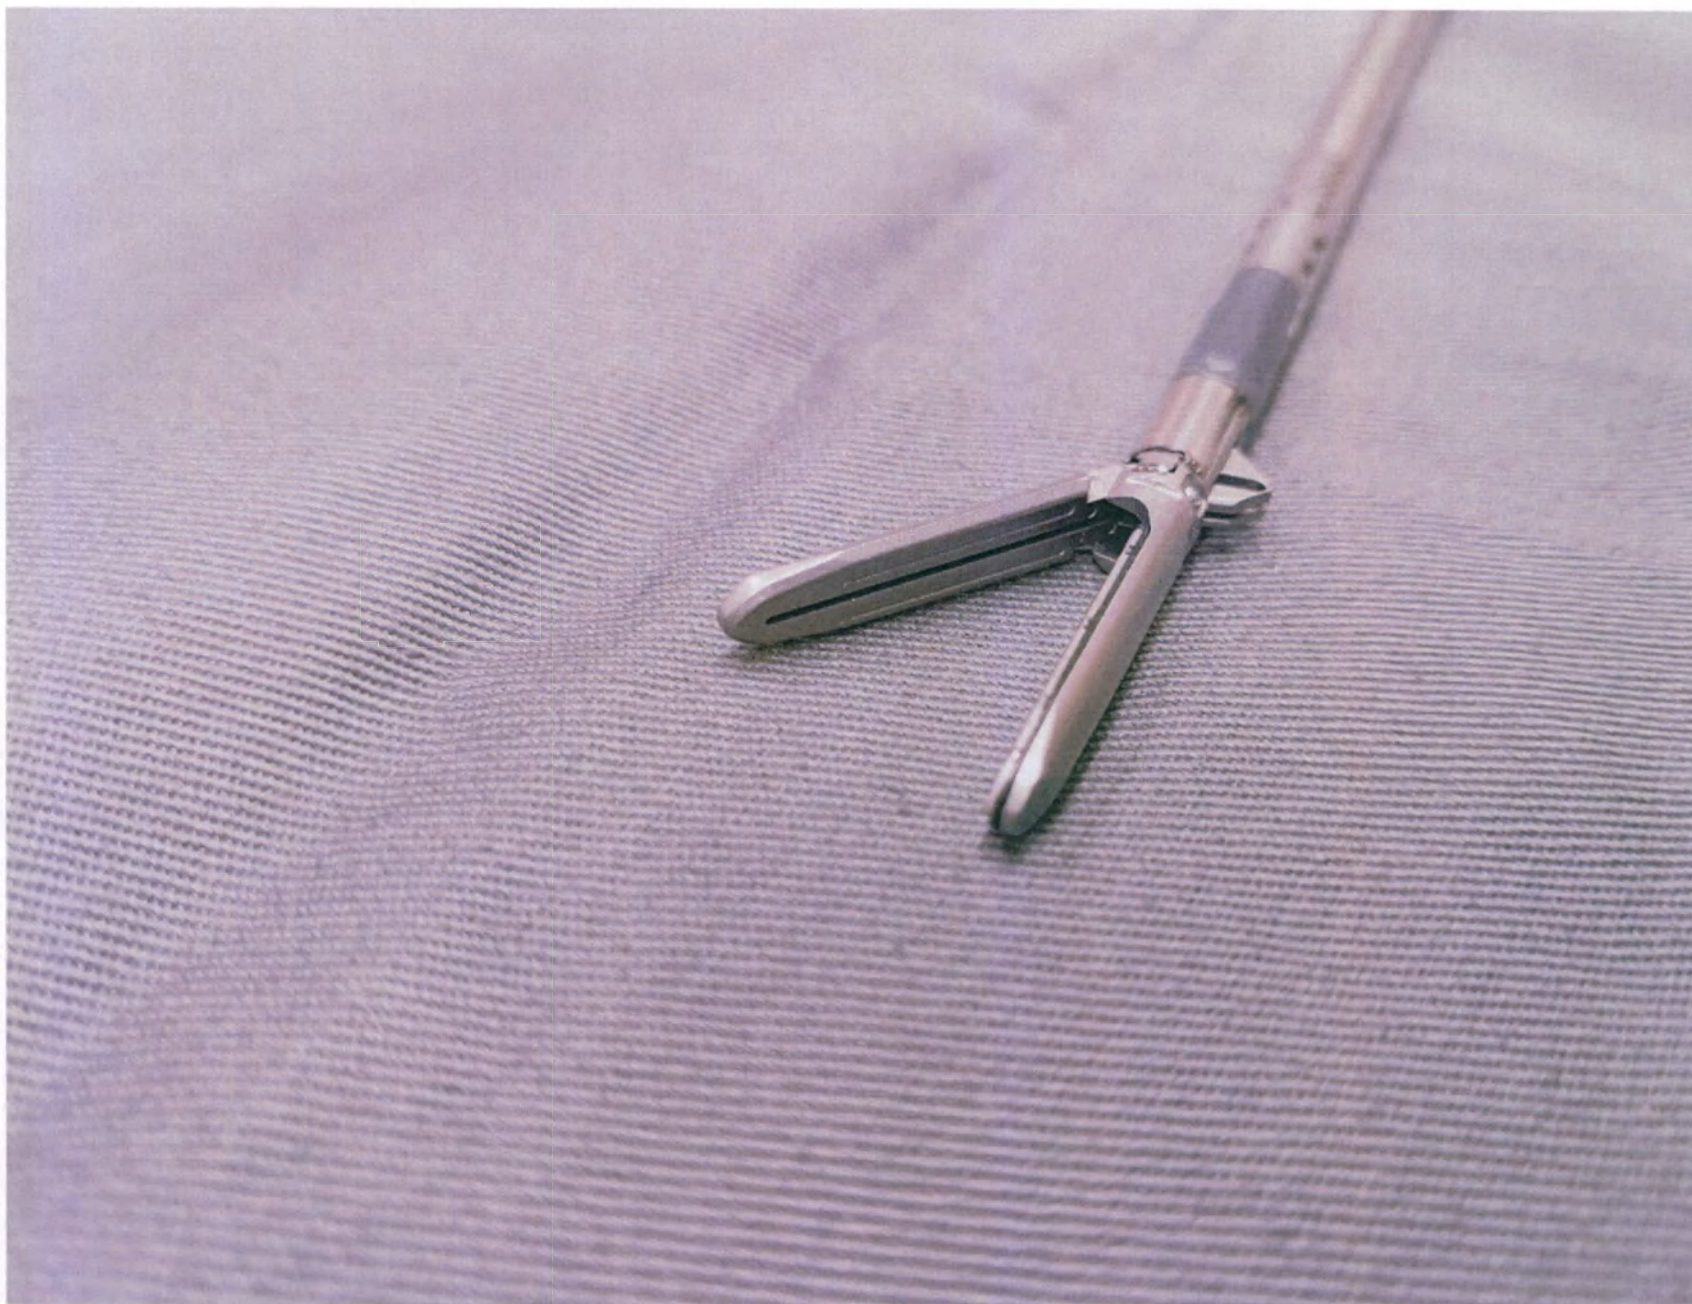


Рис. 23 – Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 37 см, с инструкцией по применению

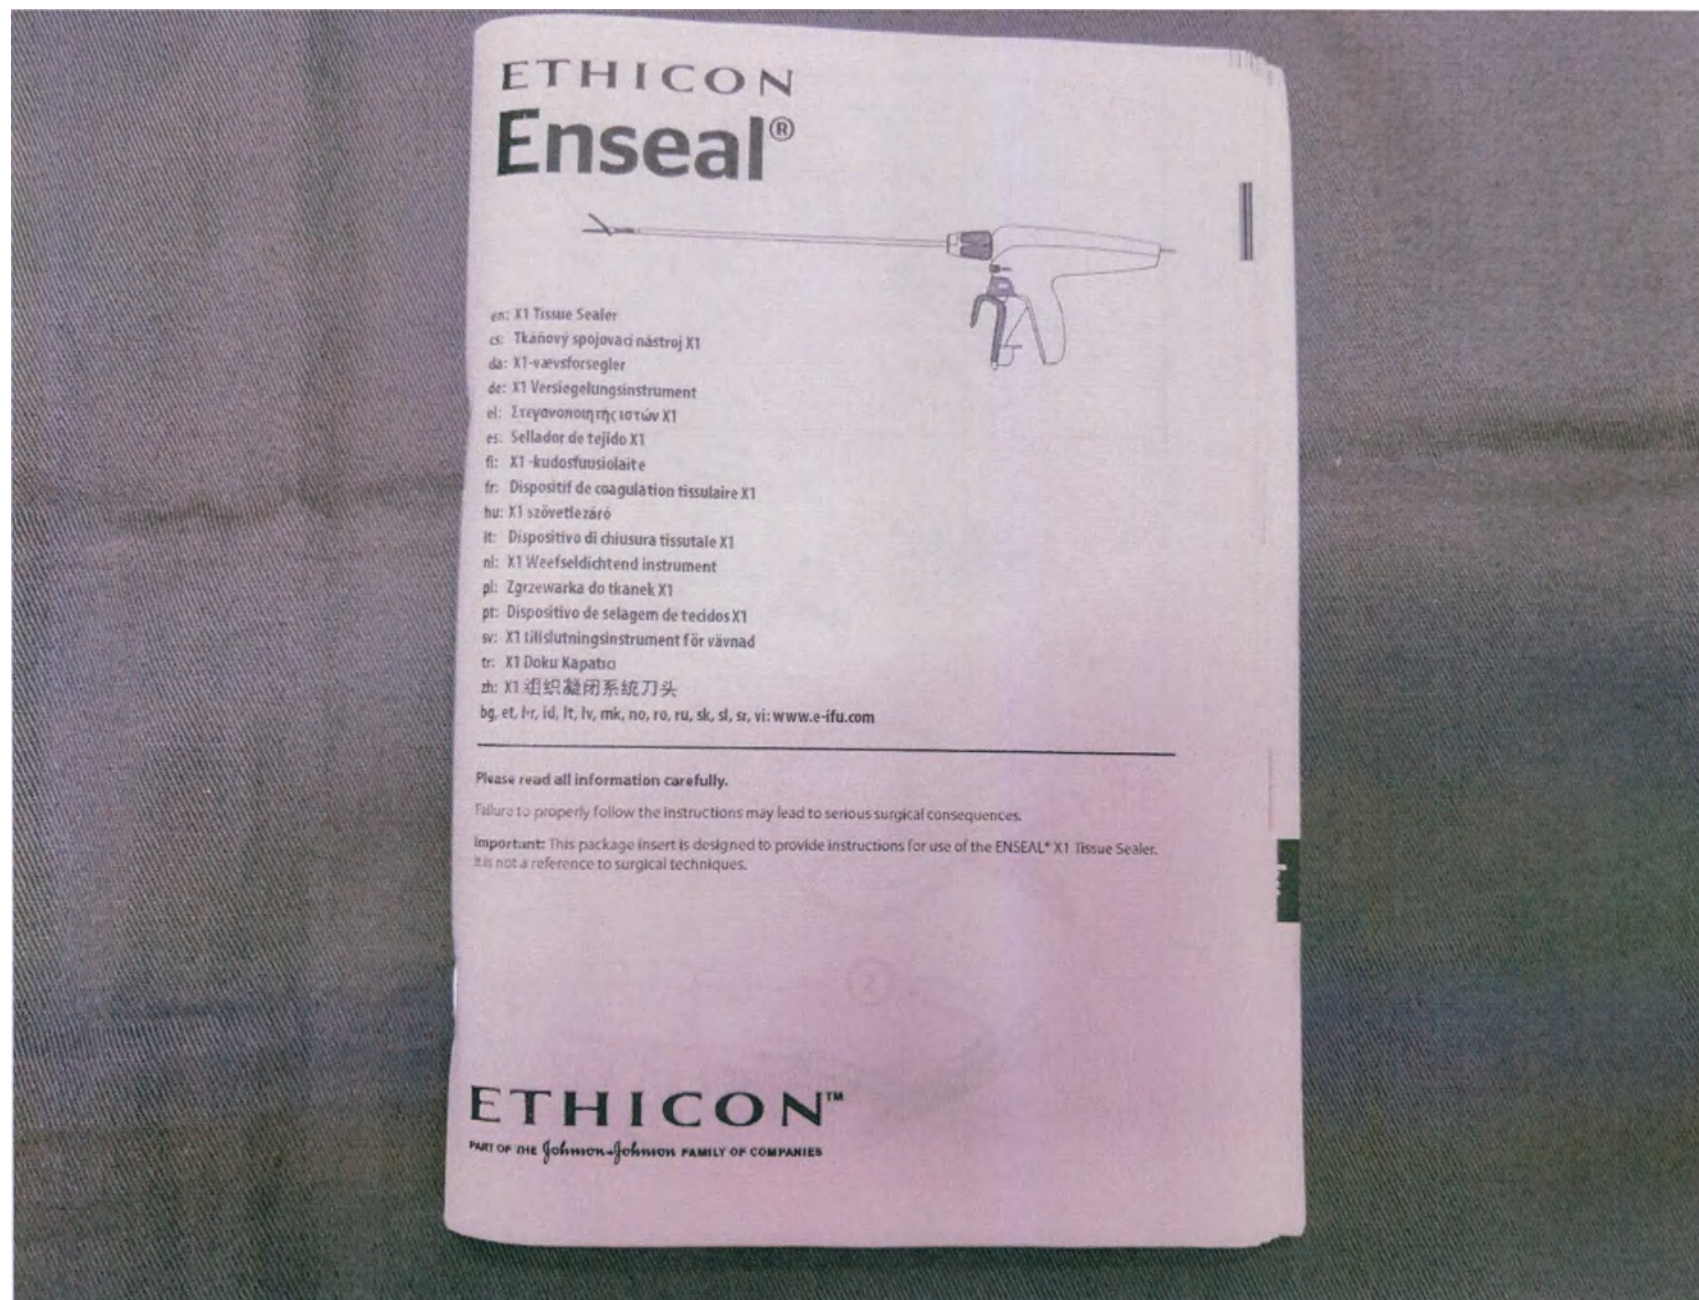


Рис. 24 – Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL® X1 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 37 см, с инструкцией по применению

REF NSLX125S

Насадка для диссекции и коагуляции ENSEAL®X1 к генератору электрохирургическому, ультразвуковому G11, с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 25 см

Область применения: Хирургия

Регистрационное удостоверение: XXX XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX

Производитель: «Этикон Эндо-Серджери, Эл-Эл-Си», США

(Ethicon Endo-Surgery, LLC)

Уполномоченный представитель производителя: ООО "Джонсон & Джонсон", 121614, Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел: +7(495)5807777

Количество: см. на упаковке

Размер: Диаметр ствола 5 мм, длина ствола 25 см

Код партии: см. на упаковке

Использовать до: см. на упаковке

Срок годности: 5 лет

Место для
технологического
кода



Рис. 25 – Пример макета русскоязычной маркировки

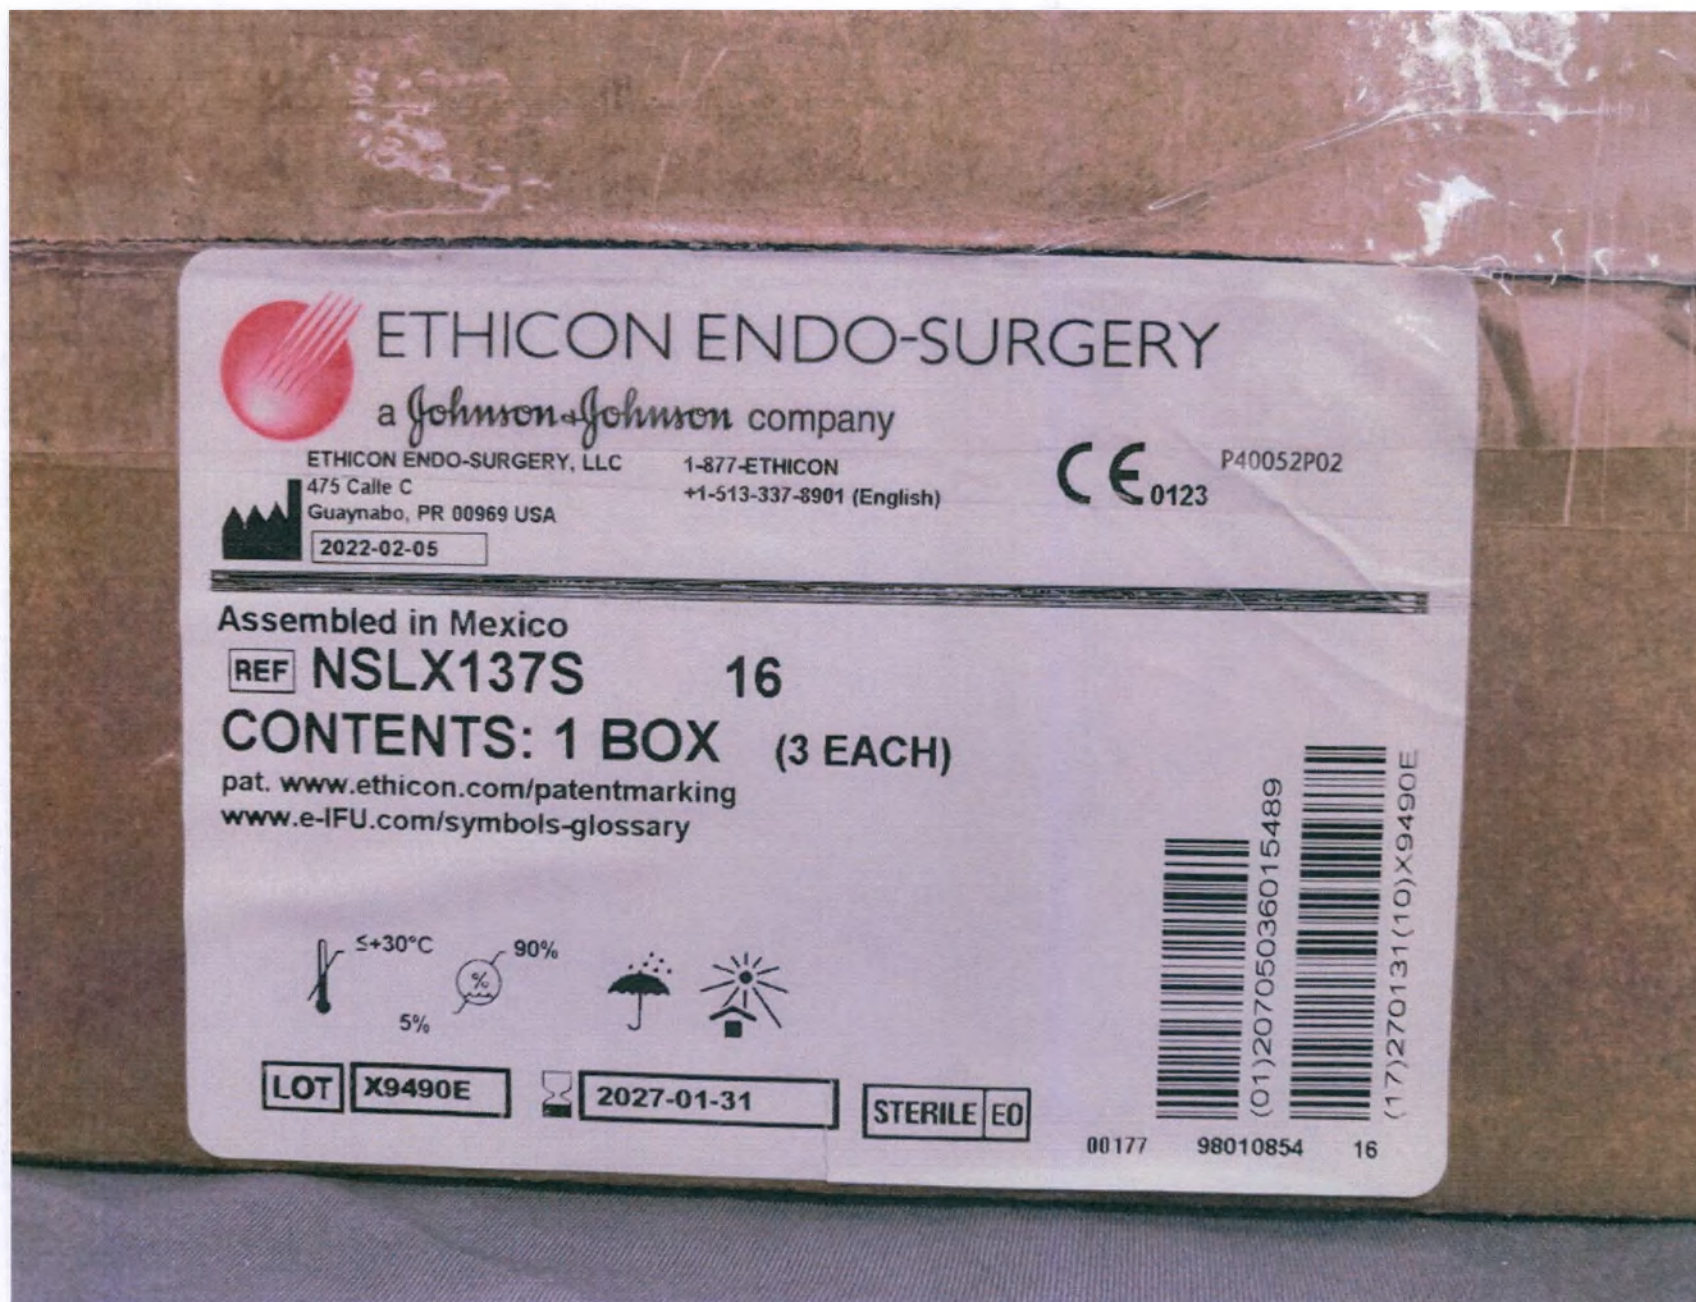


Рис. 26 – Пример макета транспортной маркировки



Рис. 27 – Пример общего вида транспортной упаковки

ПРОШУ
ПРЕДСТАВИТЬ
ПЕЧАТЬ
ПОДПИСЬ

28

Смирнов

