

СОГЛАСОВАНО

Зам. генерального директора по
научно-производственной деятель-
ности Федерального государственного
бюджетного учреждения «Центр
стратегического планирования и
управления медико-биологическими
рисками здоровью» Федерального
медико-биологического агентства
(ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

Г.А. Шипулин

2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для выявления генов металло- β -лактамаз группы NDM,
генов сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC
методом изотермической амплификации
«АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP»




Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства
(ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

Набор реагентов для выявления генов металло-β-лактамаз группы NDM, генов
сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC методом
изотермической амплификации

Форма 1

«АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP»



«РИБО-преп ТС» вариант 100 - комплект реагентов для проведения
предварительной обработки и экстракции (выделения) тотальной РНК/ ДНК из биологического материала

«LAMP-комплект» вариант FRT-96 F - комплект реагентов для
изотермической амплификации фрагментов генов металло-β-лактамаз
группы NDM, сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC с
флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»

8 °C

-16 °C
-24 °C

Применять согласно прилагаемой инструкции

При получении разупаковать в соответствии с указанными температурами хранения

LAMP-смесь-FL NDM
LAMP-смесь-FL KPC/ OXA-48

REF T-B030-1L-FRT

LOT 221014

2022-10-14

2023-07-14

ТУ 21.20.23-030- 897400-2022

Регистрационный номер:



119121, Российская Федерация, г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1


тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14; e-mail: promlab@cspfmmba.ru; сайт: www.amplitest.ru



АмплиТест

ФГБУ «ЦСП» ФМБА России
119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 10 стр. 1
Тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14
e-mail: info@cspfmmba.ru; сайт: www.cspfmmba.ru

**Фотография после вскрытия внешней упаковки набора реагентов
«АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP» Форма 1**

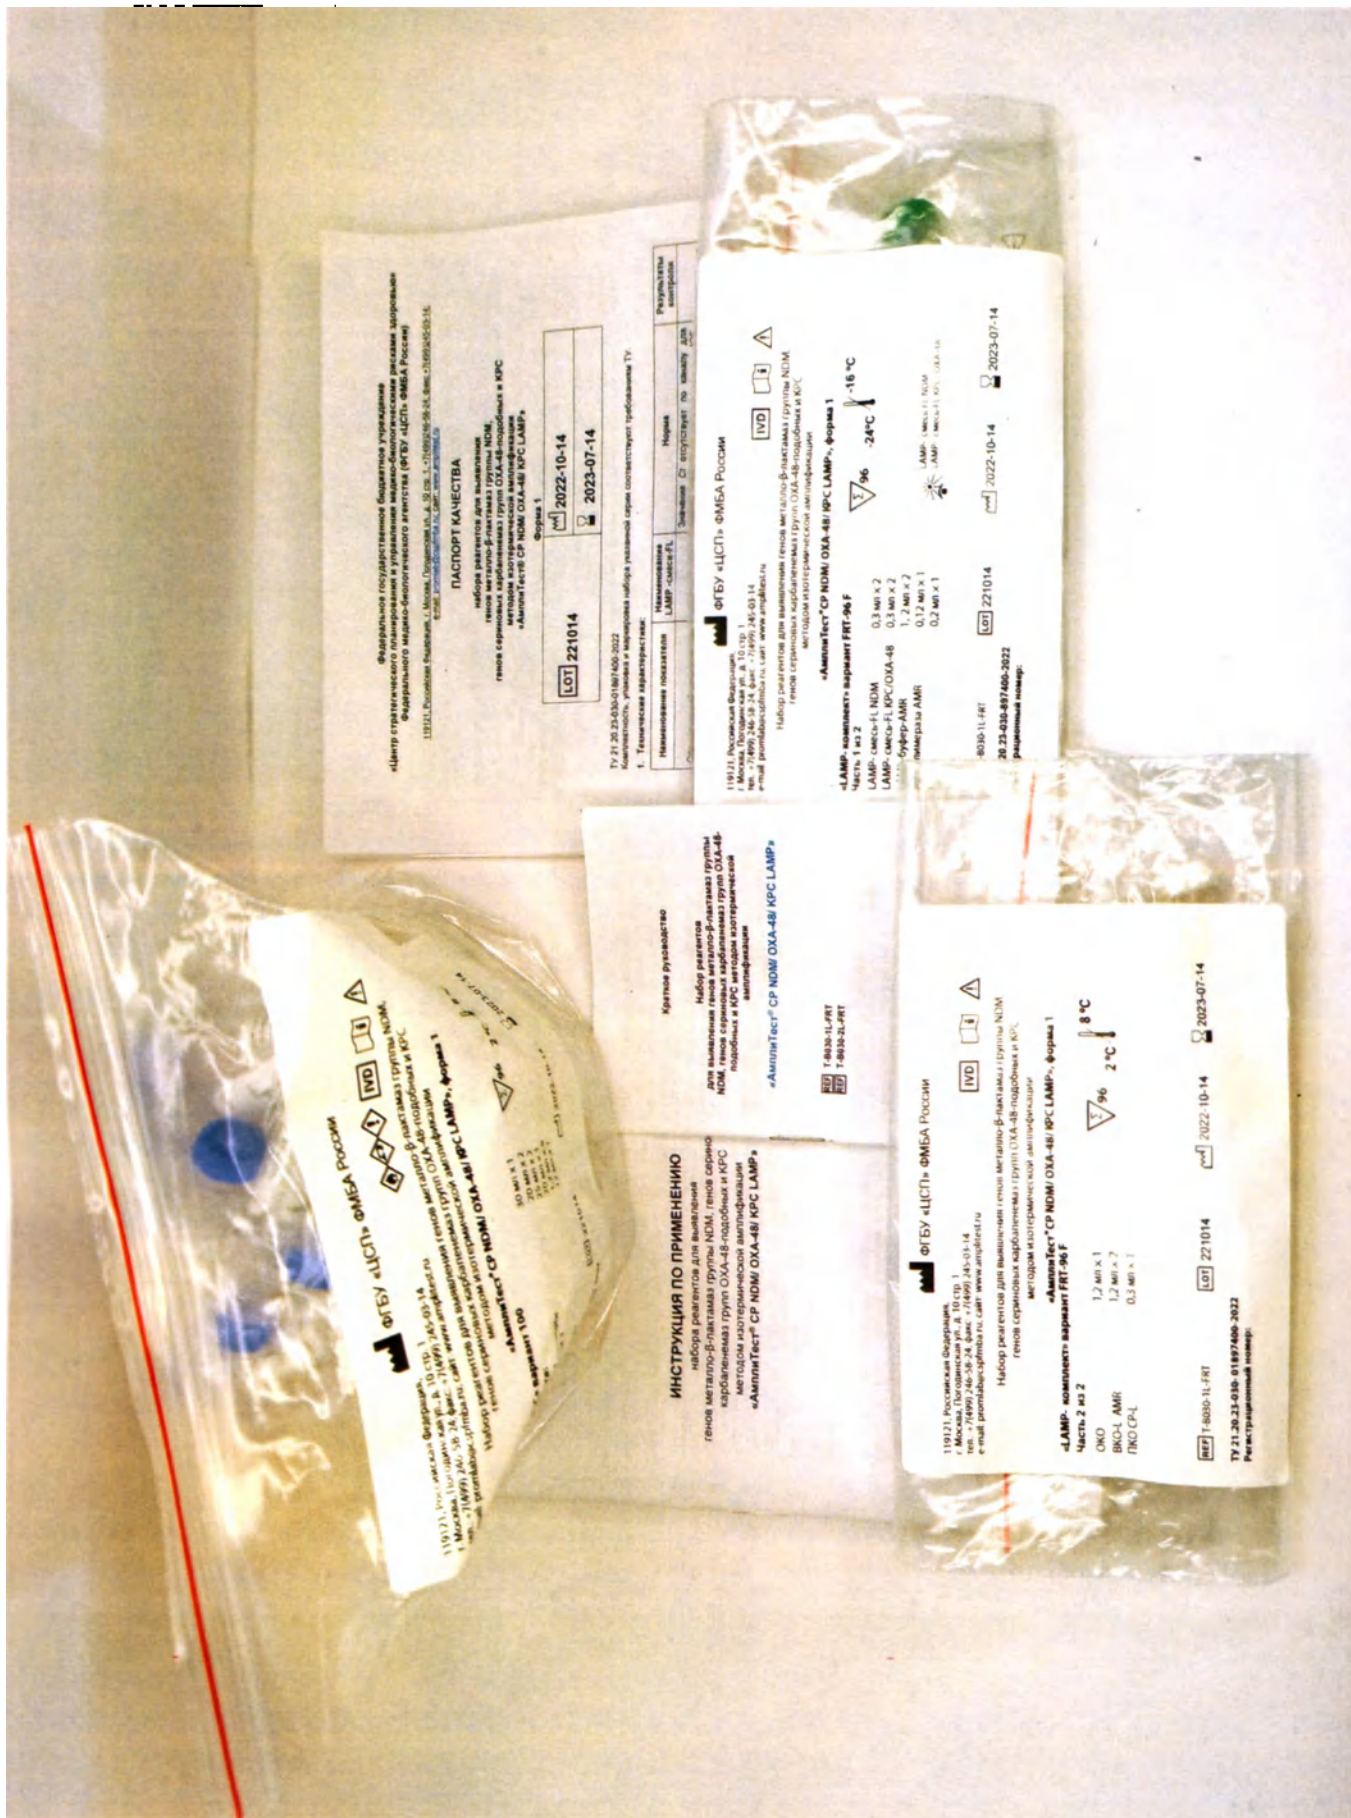


Фотография реагентов комплекта «РИБО-преп ТС» вариант 100 набора реагентов «АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP» Форма 1



Фотография реагентов комплекта «LAMP-комплект» вариант FRT-96 F» набора реагентов «АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP» Форма 1

ФГБУ «ЦСП» ФМБА России
119121, Российская Федерация,
г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14
e-mail: promlab@csfmba.ru; сайт: www.amplitest.ru



Набор реагентов для выявления генов металло-β-лактамаз группы NDM,
генов сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC
методом изотермической амплификации

«АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP», форма 1

«LAMP-комплект» вариант FRT-96 F
Часть 1 из 2

LAMP- смесь-FL NDM	0,3 мл × 2
LAMP- смесь-FL KPC/OXA-48	0,3 мл × 2
LAMP-буфер-AMR	1, 2 мл × 2
Bst полимеразы AMR	0,12 мл × 1
К-	0,2 мл × 1

Σ 96 -24°C

LAMP- смесь-FL NDM
LAMP- смесь-FL KPC/OXA-48

REF T-8030-1L-FRT

LOT 221014

2022-10-14

2023-07-14

ТУ 21.20.23-030-897400-2022

Регистрационный номер:



ФГБУ «ЦСП» ФМБА России
119121, Российская Федерация,
г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14
e-mail: promlab@csfmba.ru; сайт: www.amplitest.ru



Набор реагентов для выявления генов металло-β-лактамаз группы NDM,
генов сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC
методом изотермической амплификации

«АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP», форма 1

«LAMP-комплект» вариант FRT-96 F
Часть 2 из 2

ОКО	1,2 мл × 1
ВКО-L AMR	1,2 мл × 2
ПКО CP-L	0,3 мл × 1

Σ 96 2°C 8°C

REF T-8030-1L-FRT


LOT 221014

2022-10-14

2023-07-14

ТУ 21.20.23-030-01897400-2022

Регистрационный номер:

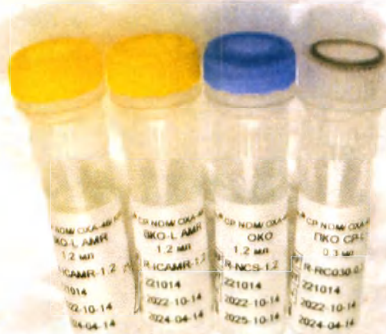

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровья» Федерального медико-биологического агентства
(ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

Набор реагентов для выявления генов металло-β-лактамаз группы NDM, генов
сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC методом
изотермической амплификации

Форма 2 «АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP»   

«Магно-Сорб-Комбо ТС» вариант 100 - комплект реагентов для
проведения предварительной обработки и экстракции (выделения)
тотальной РНК/ ДНК из биологического материала 

«LAMP-комплект» вариант FRT-96 F - комплект реагентов для
изотермической амплификации фрагментов генов металло-β-лактамаз
группы NDM, сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC с
флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» 

Применять согласно прилагаемой инструкции.
При получении разупаковать в соответствии с указанными температурами хранения

REF T-B030-2L-FRT LOT 221014  2022-10-14  2023-07-14

ТУ 21.20.23-030- 897400-2022

Регистрационный номер:   

LAMP-смесь-FL NDM
LAMP-смесь-FL KPC/ OXA-48


119121, Российская Федерация, г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 246-03-14; e-mail: promlab@csfmfa.ru; сайт: www.amplitest.ru




АмплиТест

ФГБУ «ЦСП» ФМБА России
119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 10 стр. 1
Тел.: 8 (499) 246-58-24; факс: 8 (499) 246-03-14
e-mail: info@csfmfa.ru, сайт: www.csfmfa.ru

Фотография после вскрытия внешней упаковки набора реагентов «АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP» Форма 2

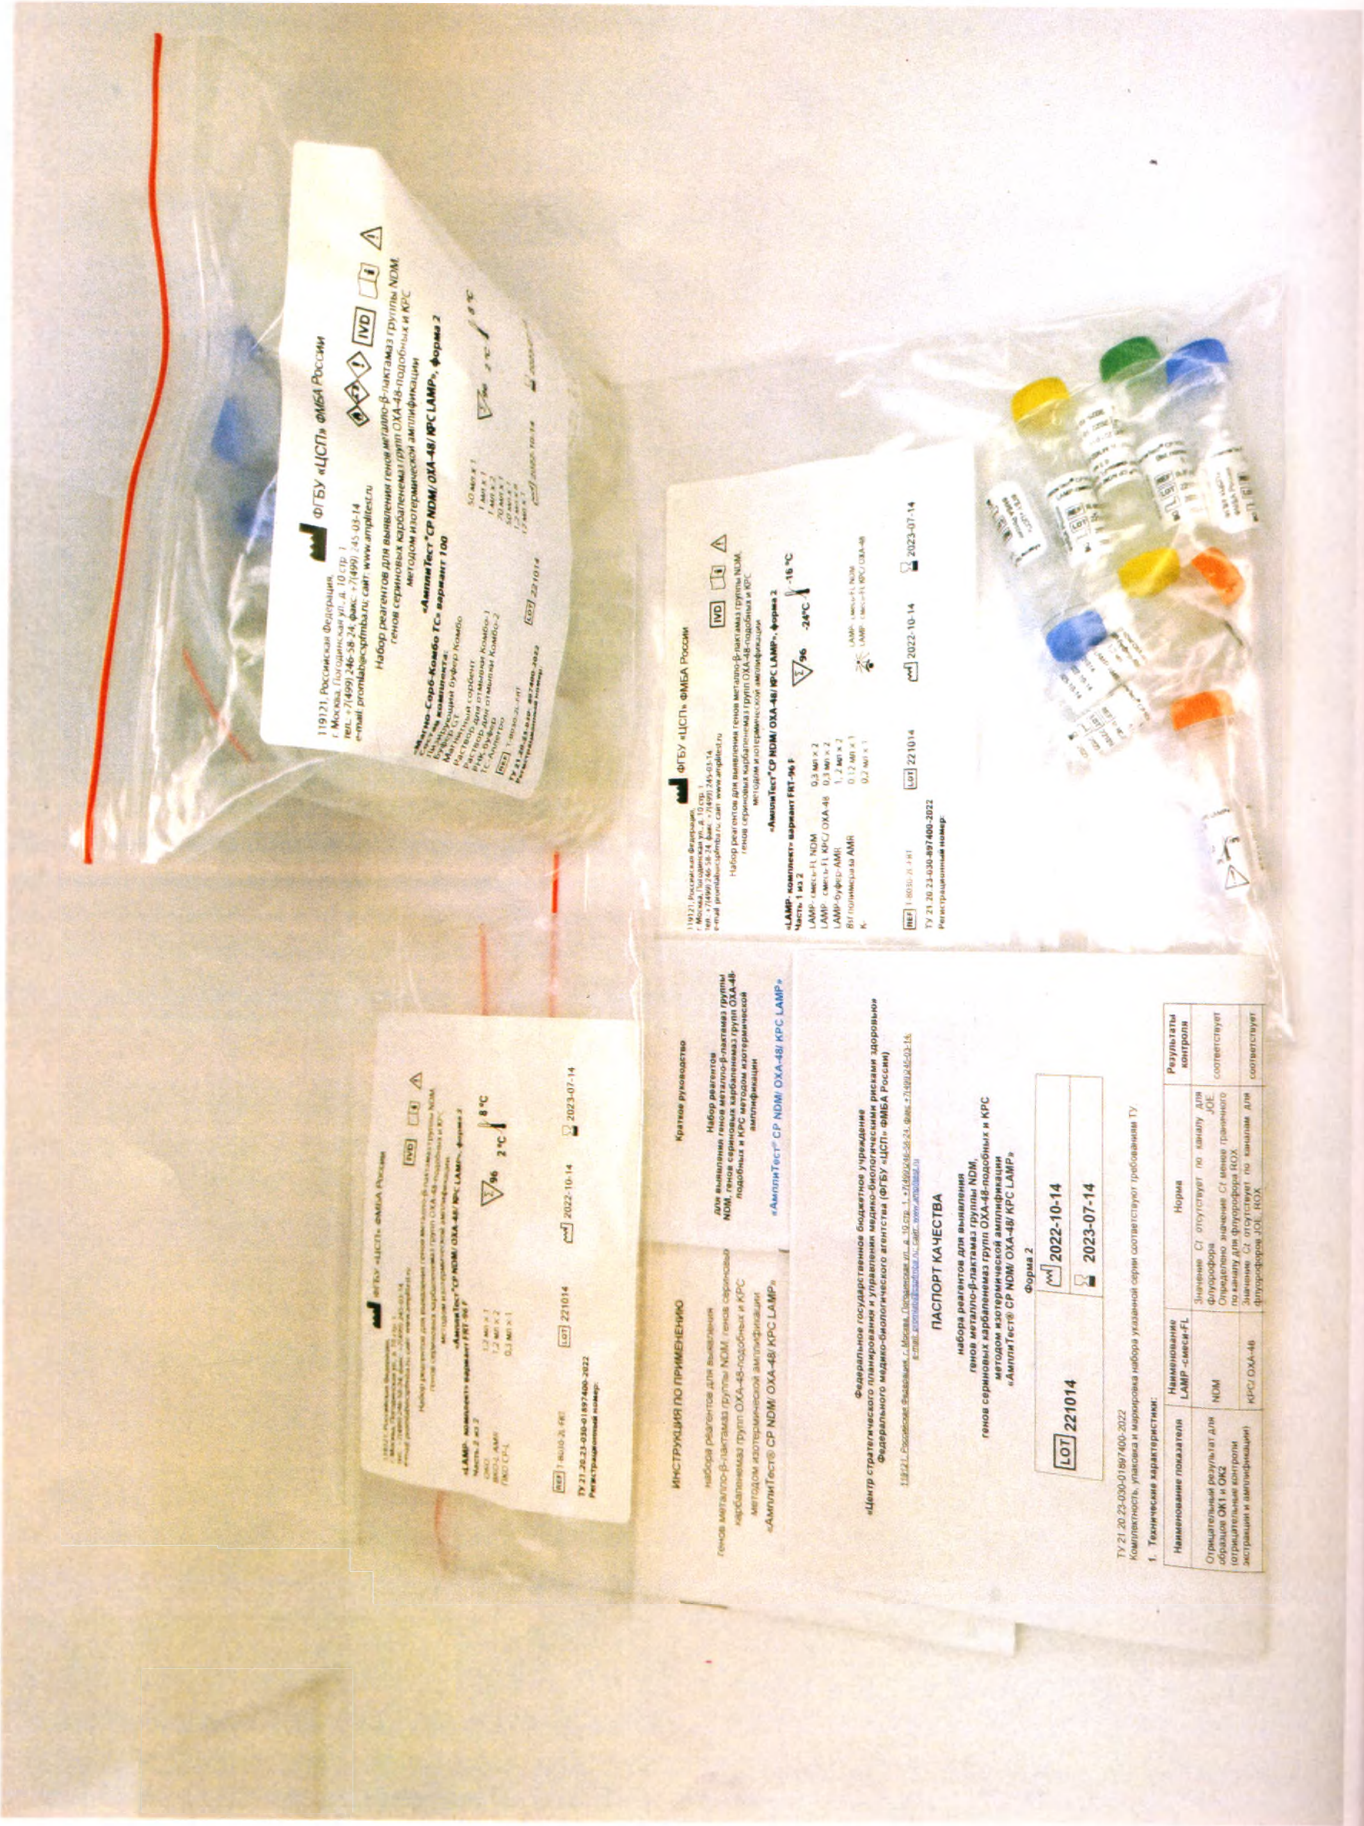

Фотография реагентов комплекта «Магно-Сорб-Комбо ТС» вариант 100 набора реагентов «АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP» Форма 2

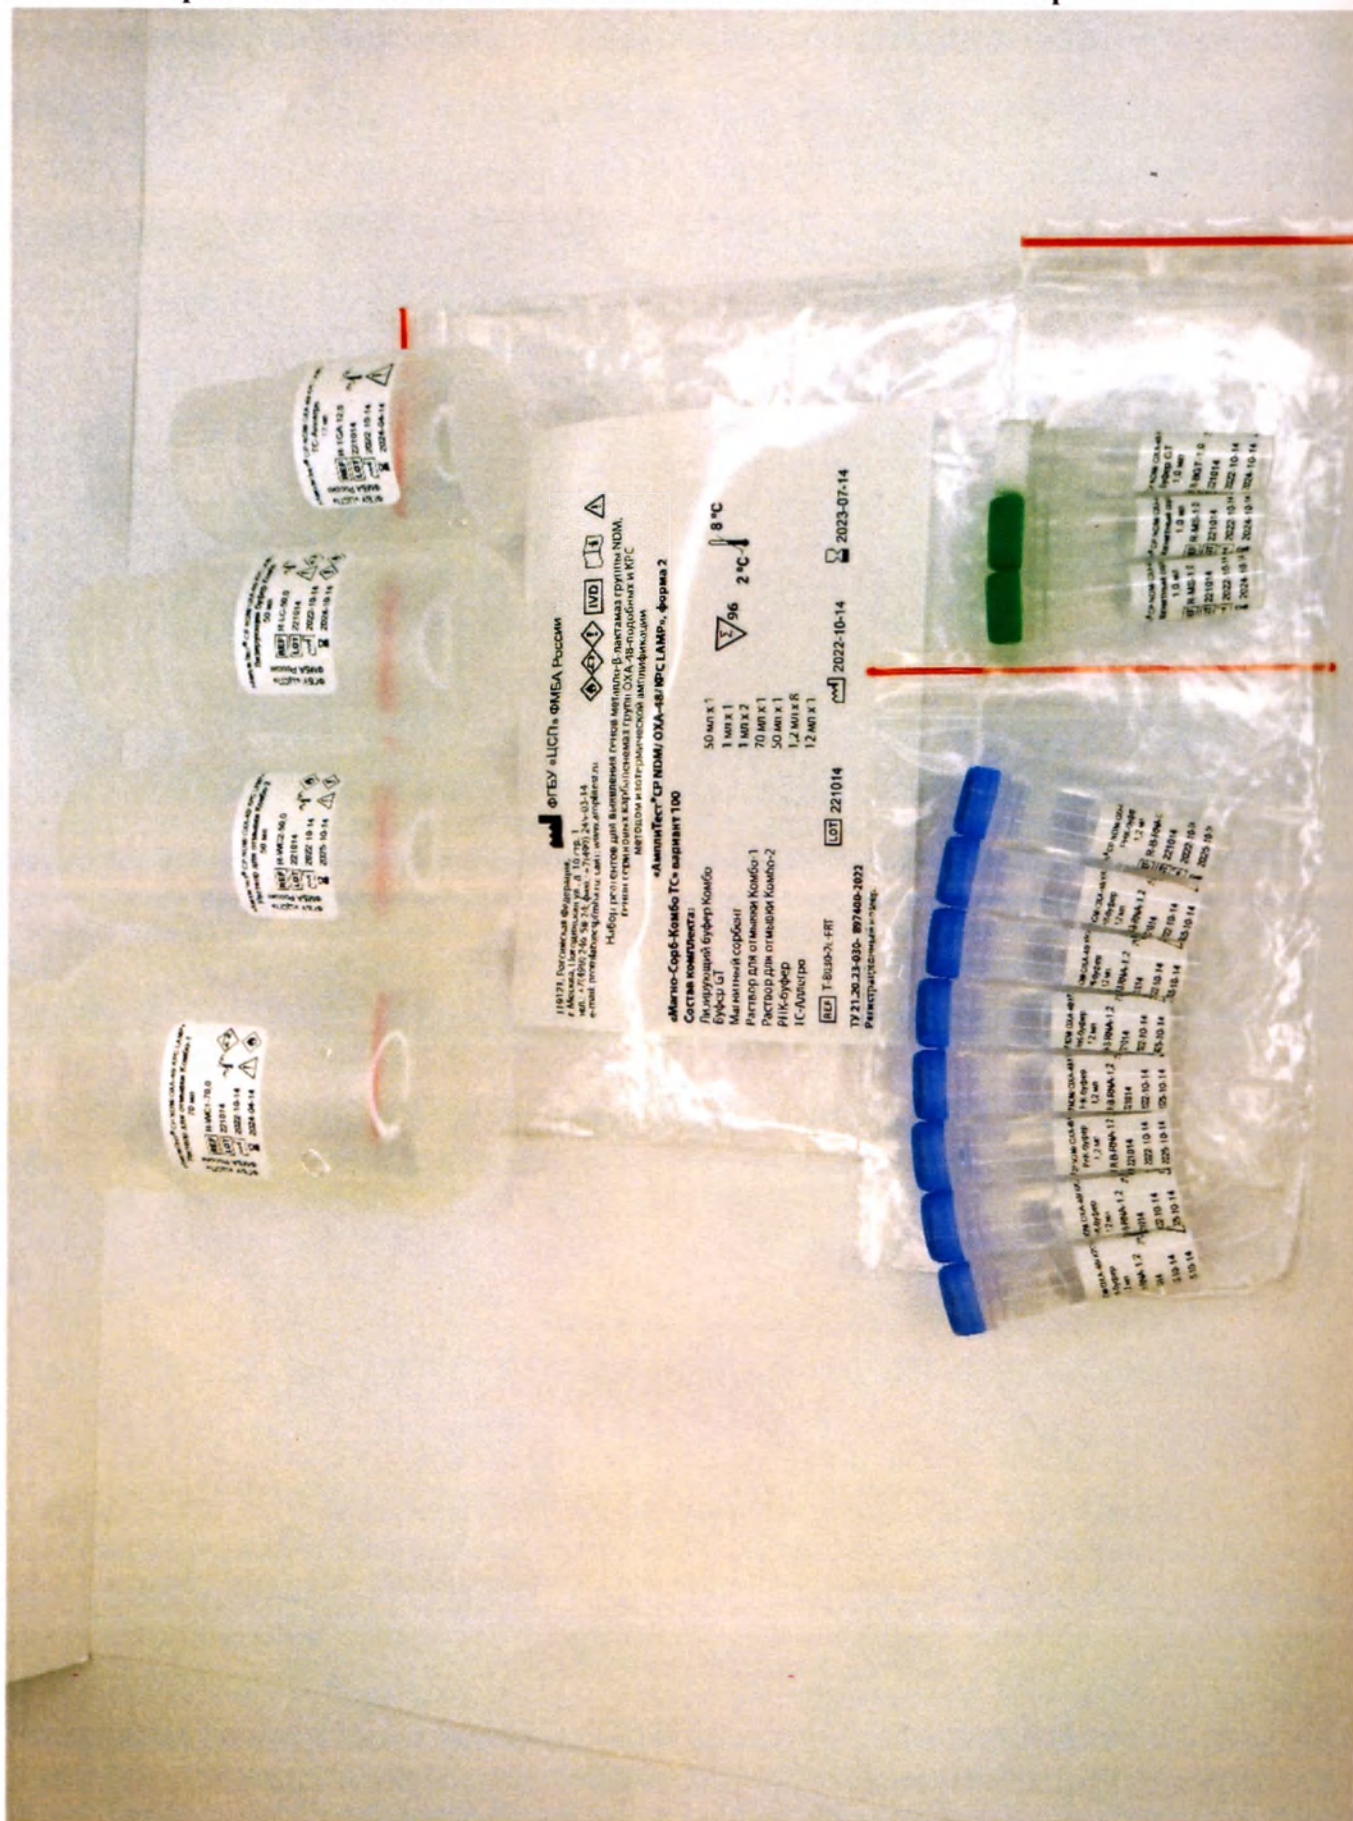

Фотография реагентов комплекта «LAMP-комплект» вариант FRT-96 F» набора реагентов «АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP» Форма 2





Пронумеровано, прошнуровано и скреплено

печатью

лист 26

Директор центра постгеномных технологий ФГБУ «ЦСП»
ФМБА России

Г.А. Шипулин

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора
по научно-производственной
деятельности федерального
государственного бюджетного
учреждения «Центр стратегического
планирования и управления медико-
биологическими рисками здоровью»
Федерального медико-
биологического агентства
(ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

Г.А.Шипулин

2022 г.



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ

набора реагентов для выявления
генов металло-β-лактамаз группы NDM,
генов сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC
методом изотермической амплификации
«АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP»

Образцы этикеток на внутренней упаковке (пробирки)

Форма 1

Название реагента	Образец этикетки	Название реагента	Образец этикетки
«РИБО-преп ТС» вариант 100			
Раствор для лизиса		Раствор для преципитации	
Раствор для отмывки 3		Раствор для отмывки 4	
РНК-буфер		ТС-Аллерго	




Образцы этикеток на внутренней упаковке (пробирки)

Форма 1

Название реагента	Образец этикетки	Название реагента	Образец этикетки
«LAMP-комплект» вариант FRT-96 F, часть 1			
LAMP-смесь-FL NDM	«Asentra Tec» CP NDM OXA-48/ KPC LAMP LAMP-смесь-FL NDM 0.3 ml REF R-M301 0.3 LOT Z21014 2022-10-14 2025-10-14 	LAMP-смесь-FL KPC/ OXA-48	«Asentra Tec» CP NDM OXA-48/ KPC LAMP LAMP-смесь-FL KPC/ OXA-48 0.3 ml REF R-M302 0.3 LOT Z21014 2022-10-14 2025-10-14 
LAMP-буфер-AMR	«Asentra Tec» CP NDM OXA-48/ KPC LAMP LAMP-буфер-AMR 1.2 ml REF R-LAMP-AMR 1.2 LOT Z21014 2022-10-14 2025-10-14 	Bst полимеразы AMR	«Asentra Tec» CP NDM OXA-48/ KPC LAMP Bst полимеразы AMR 0.12 ml REF R-P-AMR 0.12 LOT Z21014 2022-10-14 2024-10-14 
K-	«Asentra Tec» CP NDM OXA-48/ KPC LAMP K 0.2 ml REF R-NC-RT 0.2 LOT Z21014 2022-10-14 2025-10-14 	—	—
«LAMP-комплект» вариант FRT-96 F, часть 2			
BKO-L AMR	«Asentra Tec» CP NDM OXA-48/ KPC LAMP BKO-L AMR 1.2 ml REF R-ICAMR 1.2 LOT Z21014 2022-10-14 2024-04-14 	ПКО CP-L	«Asentra Tec» CP NDM OXA-48/ KPC LAMP ПКО CP-L 0.3 ml REF R-RC030-0.3 LOT Z21014 2022-10-14 2024-04-14 
OKO	«Asentra Tec» CP NDM OXA-48/ KPC LAMP OKO 1.2 ml REF R-NCS 1.2 LOT Z21014 2022-10-14 2025-10-14 	—	—

Образцы этикеток на внутренней упаковке (пробирки)

Форма 2

Название реагента	Образец этикетки	Название реагента	Образец этикетки
«Магно-Сорб-Комбо ТС» вариант 100			
Лизирующий буфер Комбо	«Asentra Tec» CP NDM OXA-48 KPC LAMP» Лизирующий буфер Комбо 50 мл REF R-LC-50.0 LOT 221014 2022-10-14 2024-10-14 	Буфер GT	«Asentra Tec» CP NDM OXA-48 KPC LAMP» Буфер GT 1.0 мл REF R-BGT-1.0 LOT 221014 2022-10-14 2024-10-14 
Магнитный сорбент	«Asentra Tec» CP NDM OXA-48 KPC LAMP» Магнитный сорбент 1.0 мл REF R-MS-1.0 LOT 221014 2022-10-14 2024-10-14 	РНК-буфер	«Asentra Tec» CP NDM OXA-48 KPC LAMP» РНК-буфер 1.2 мл REF R-B-RNA-1.2 LOT 221014 2022-10-14 2025-10-14 
Раствор для отмывки Комбо-1	«Asentra Tec» CP NDM OXA-48 KPC LAMP» Раствор для отмывки Комбо-1 70 мл REF R-WC1-70.0 LOT 221014 2022-10-14 2024-04-14 	Раствор для отмывки Комбо-2	«Asentra Tec» CP NDM OXA-48 KPC LAMP» Раствор для отмывки Комбо-2 50 мл REF R-WC2-50.0 LOT 221014 2022-10-14 2025-10-14 
ТС-Аллерго	«Asentra Tec» CP NDM OXA-48 KPC LAMP» ТС-Аллерго 12 мл REF R-TCA-12.0 LOT 221014 2022-10-14 2024-04-14 	—	—
«LAMP-комплект» вариант FRT-96 F, часть 1			
LAMP-смесь-FL NDM	«Asentra Tec» CP NDM OXA-48 KPC LAMP» LAMP-смесь-FL NDM 0.3 мл REF R-M301-0.3 LOT 221014 2022-10-14 2025-10-14 	LAMP-смесь-FL KPC/ OXA-48	«Asentra Tec» CP NDM OXA-48 KPC LAMP» LAMP-смесь-FL KPC/ OXA-48 0.3 мл REF R-M302-0.3 LOT 221014 2022-10-14 2025-10-14 
LAMP-буфер-AMR	«Asentra Tec» CP NDM OXA-48 KPC LAMP» LAMP-буфер-AMR 1.2 мл REF R-LAMP-AMR-1.2 LOT 221014 2022-10-14 2025-10-14 	Bst полимеразы AMR	«Asentra Tec» CP NDM OXA-48 KPC LAMP» Bst полимеразы AMR 0.12 мл REF R-P-AMR-0.12 LOT 221014 2022-10-14 2024-10-14 
K-	«Asentra Tec» CP NDM OXA-48 KPC LAMP» K 0.2 мл REF R-NC-RT-0.2 LOT 221014 2022-10-14 2025-10-14 	—	—

Образцы этикеток на внутренней упаковке (пробирки)

Форма 2

Название реагента	Образец этикетки	Название реагента	Образец этикетки
«LAMP-комплект» вариант FRT-96 F, часть 2			
ВКО-L AMR	«АмплиТекст» CP NDM/OXA-48/KPC LAMP ВКО-L AMR 1,2 мл REF R-ICAMR-1,2 LOT 221014 2022-10-14 2024-04-14 ФГБУ «ЦСП» ФМБА России 25°C !	ПКО CP-L	«АмплиТекст» CP NDM/OXA-48/KPC LAMP ПКО CP-L 0,3 мл REF R-RC028-0,3 LOT 221014 2022-10-14 2024-04-14 ФГБУ «ЦСП» ФМБА России 25°C !
ОКО	«АмплиТекст» CP NDM/OXA-48/KPC LAMP ОКО 1,2 мл REF R-NCS-1,2 LOT 221014 2022-10-14 2025-10-14 ФГБУ «ЦСП» ФМБА России 25°C !	—	—

Образцы наклеек на внешней упаковке (коробка)

Форма 1



Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства
(ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

Набор реагентов для выявления генов металло-β-лактамаз группы NDM, генов
сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC методом
изотермической амплификации

Форма 1

«АмплиТест®CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP»



«РИБО-преп ТС» вариант 100 - комплект реагентов для проведения
предварительной обработки и экстракции (выделения) тотальной РНК/ ДНК 2 °C 8 °C

«LAMP-комплект» вариант FRT-96 F - комплект реагентов для
изотермической амплификации фрагментов генов металло-β-лактамаз
группы NDM, сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC с
флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» -16 °C -24 °C

Применять согласно прилагаемой инструкции

При получении разукладывать в соответствии с указанными температурами хранения

LAMP-смесь-FL NDM
LAMP-смесь-FL KPC/ OXA-48

REF T-B030-1L-FRT

LOT 221014

2022-10-14

2023-07-14

ТУ 21.20.23-030- 897400-2022

Регистрационный номер:



119121, Российская Федерация, г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 246-03-14; e-mail: promlab@csfmba.ru; сайт: www.amplitest.ru

Образцы наклеек на внешней упаковке (коробка)

Форма 2



Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства
(ФГБУ «ЦСП» ФМБА России)

Набор реагентов для выявления генов металло-β-лактамаз группы NDM, генов
сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC методом
изотермической амплификации

Форма 2

«АмплиТест®CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP»



«Магно-Сорб-Комбо ТС» вариант 100 - комплект реагентов для
проведения предварительной обработки и экстракции (выделения)
тотальной РНК/ ДНК из биологического материала 2 °C 8 °C

«LAMP-комплект» вариант FRT-96 F - комплект реагентов для
изотермической амплификации фрагментов генов металло-β-лактамаз
группы NDM, сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC с
флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» -16 °C -24 °C

Применять согласно прилагаемой инструкции

При получении разукладывать в соответствии с указанными температурами хранения

LAMP-смесь-FL NDM
LAMP-смесь-FL KPC/ OXA-48

REF T-B030-2L-FRT

LOT 221014

2022-10-14

2023-07-14

ТУ 21.20.23-030- 897400-2022

Регистрационный номер:



119121, Российская Федерация, г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 246-03-14; e-mail: promlab@csfmba.ru; сайт: www.amplitest.ru

Образцы наклеек на внешней упаковке (пакет Zip-lock)

Форма 1

«РИБО-преп ТС» вариант 100

119121, Российская Федерация,
г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14
e-mail: promlab@csrfmba.ru; сайт: www.amplitest.ru



ФГБУ «ЦСП» ФМБА России



Набор реагентов для выявления генов металло-β-лактамаз группы NDM,
генов сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC
методом изотермической амплификации

«АмплиТест®СР NDM/ OXA-48/ KPC LAMP», форма 1

«РИБО-преп ТС» вариант 100

Состав комплекта:

Раствор для лизиса	30 мл x 1
Раствор для преципитации	20 мл x 2
Раствор для отмывки 3	25 мл x 2
Раствор для отмывки 4	20 мл x 1
РН-буфер	1,2 мл x 8
ТС-Аллегро	12 мл x 1



REF T-8030-1L-FRT

LOT 221014

2022-10-14

2023-07-14

ТУ 21.20.23-030-897400-2022

Регистрационный номер:

«LAMP-комплект» вариант FRT-96 F, часть 1

119121, Российская Федерация,
г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14
e-mail: promlab@csrfmba.ru; сайт: www.amplitest.ru



ФГБУ «ЦСП» ФМБА России



Набор реагентов для выявления генов металло-β-лактамаз группы NDM,
генов сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC
методом изотермической амплификации

«АмплиТест®СР NDM/ OXA-48/ KPC LAMP», форма 1

«LAMP-комплект» вариант FRT-96 F

Часть 1 из 2

LAMP-смесь-FL NDM	0,3 мл x 2
LAMP-смесь-FL KPC/OXA-48	0,3 мл x 2
LAMP-буфер-AMR	1, 2 мл x 2
Bst полимеразы AMR	0,12 мл x 1
K-	0,2 мл x 1



LAMP-смесь-FL NDM
LAMP-смесь-FL KPC/ OXA-48

REF T-8030-1L-FRT

LOT 221014

2022-10-14

2023-07-14

ТУ 21.20.23-030-897400-2022

Регистрационный номер:

Образцы наклеек на внешней упаковке (пакет Zip-lock)

Форма 1

«LAMP-комплект» вариант FRT-96 F, часть 2



ФГБУ «ЦСП» ФМБА России

119121, Российская Федерация,
г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14
e-mail: promlab@csrfmba.ru; сайт: www.amplitest.ru




Набор реагентов для выявления генов металло-β-лактамаз группы NDM,
генов сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC
методом изотермической амплификации

«АмплиТест[®] CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP», форма 1

«LAMP-комплект» вариант FRT-96 F

Часть 2 из 2

ОКО	1,2 мл x 1
ВКО-L AMR	1,2 мл x 2
ПКО CP-L	0,3 мл x 1



REF T-8030-1L-FRT

LOT 221014

2022-10-14

2023-07-14

ТУ 21.20.23-030-01097400-2022
Регистрационный номер:

Образцы наклеек на внешней упаковке (пакет Zip-lock)

Форма 2

«Магно-Сорб-Комбо ТС» вариант 100



ФГБУ «ЦСП» ФМБА России

119121, Российская Федерация,
г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14
e-mail: promlab@csrfmba.ru; сайт: www.amplitest.ru




Набор реагентов для выявления генов металло-β-лактамаз группы NDM,
генов сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC
методом изотермической амплификации

«АмплиТест[®] CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP», форма 2

«Магно-Сорб-Комбо ТС» вариант 100

Состав комплекта:

Лизирующий буфер Комбо	50 мл x 1
Буфер GT	1 мл x 1
Магнитный сорбент	1 мл x 2
Раствор для отмывки Комбо-1	70 мл x 1
Раствор для отмывки Комбо-2	50 мл x 1
РНК-буфер	1,2 мл x 8
ТС-Аллегро	12 мл x 1



REF T-8030-2L-FRT

LOT 221014

2022-10-14

2023-07-14

ТУ 21.20.23-030-007400-2022
Регистрационный номер:

Образцы наклеек на внешней упаковке (пакет Zip-lock)

Форма 2

«LAMP-комплект» вариант FRT-96 F, часть 1



ФГБУ «ЦСП» ФМБА России

119121, Российская Федерация,
г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14
e-mail: promlab@csrfmba.ru; сайт: www.amplitest.ru



Набор реагентов для выявления генов металло-β-лактамаз группы NDM,
генов сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC
методом изотермической амплификации

«АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP», форма 2

«LAMP-комплект» вариант FRT-96 F
Часть 1 из 2

LAMP- смесь-FL NDM	0,3 мл × 2
LAMP- смесь-FL KPC/ OXA-48	0,3 мл × 2
LAMP-буфер-AMR	1, 2 мл × 2
Bst полимеразы AMR	0,12 мл × 1
K-	0,2 мл × 1



-24°C → -16°C



LAMP- смесь-FL NDM
LAMP- смесь-FL KPC/ OXA-48

REF T-8030-2L-FRT

LOT 221014

2022-10-14

2023-07-14

ТУ 21.20.23-030-897400-2022

Регистрационный номер:

«LAMP-комплект» вариант FRT-96 F, часть 2



ФГБУ «ЦСП» ФМБА России

119121, Российская Федерация,
г. Москва, Погодинская ул., д. 10 стр. 1
тел.: +7(499) 246-58-24; факс: +7(499) 245-03-14
e-mail: promlab@csrfmba.ru; сайт: www.amplitest.ru



Набор реагентов для выявления генов металло-β-лактамаз группы NDM,
генов сериновых карбапенемаз групп OXA-48-подобных и KPC
методом изотермической амплификации

«АмплиТест® CP NDM/ OXA-48/ KPC LAMP», форма 2

«LAMP-комплект» вариант FRT-96 F

Часть 2 из 2

ОКО	1,2 мл × 1
ВКО-L AMR	1,2 мл × 2
ПКО CP-L	0,3 мл × 1



2°C → 8°C

REF T-8030-2L-FRT

LOT 221014

2022-10-14

2023-07-14

ТУ 21.20.23-030-01897400-2022

Регистрационный номер:

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью

8 лист 08

Директор центра постгеномных технологий ФГБУ «ЦСП»
ФМБА России



Г.А. Шипулин