


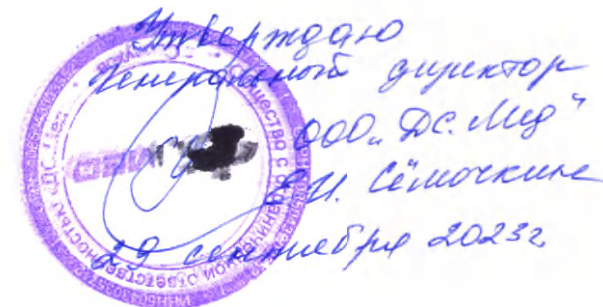

**Макеты маркировки составных частей и принадлежностей Установки
оториноларингологической DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 в вариантах
исполнения**

Наим- ние	Макет
Макет маркировки ЛОР-установки	 Сделано в России УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ:  SN место для QR-кода    IPX0 СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА: (230±23)В ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: _____ВА ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: _____ВА ЧАСТОТА СЕТИ: 50Гц ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: компрессор аспирационный: _____л/мин компрессор распыления: _____л/мин помпа промывочная: _____л/мин  РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Шнур сетевого питания	Макет маркировки упаковки ЛОР-установки
 УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AссистЕНТ по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ШНУР СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.ОСЕНЬКОЕ, Г.СЕРГОВО, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, Д. 6, ОФИС 1, тел.: +7(495)2501152, info@ds-med.ru, www.ds-med.ru	ds.MED Сделано в России МЕСТО _____ УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AссистЕНТ по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: _____  MPLTTT SN _____ МЕСТО для QR-кода ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм _____ МАССА ВРУЧТО, кг _____ МАССА ЧИСТО, кг _____    РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____ от _____ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г.ОСЕНЬКОЕ, Г.СЕРГОВО, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, Д. 6, ОФИС 1, тел.: +7(495)2501152, info@ds-med.ru, www.ds-med.ru ТУ и/или ЕСИП УТИЛИЗОВАНЫ Условия транспортирования  Условия хранения     

Стакан пластиковый для временного хранения чистых гибких эндоскопов	Стакан пластиковый для временного хранения использованных жестких эндоскопов	Стакан пластиковый для временного хранения чистых жестких эндоскопов
 УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.Assistent по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 СТАКАН ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ЧИСТЫХ ГИБКИХ ЭНДОСКОПОВ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О. СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, Д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155. www.ds-med.ru info@ds-med.ru	 УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.Assistent по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 СТАКАН ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЖЕСТКИХ ЭНДОСКОПОВ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О. СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, Д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155. www.ds-med.ru info@ds-med.ru	 УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.Assistent по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 СТАКАН ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ЧИСТЫХ ЖЕСТКИХ ЭНДОСКОПОВ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О. СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, Д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155. www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Стакан пластиковый для временного хранения использованных гибких эндоскопов	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.Assistent по ТУ 32.50.50-002-00671063-2022 СТАКАН ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ГИБКИХ ЭНДСКОПОВ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Емкость накопительная для секрета	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.Assistent по ТУ 32.50.50-002-00671063-2022 ЕМКОСТЬ НАКОПИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СЕКРЕТА   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Адаптер олив	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.Assistent по ТУ 32.50.50-002-00671063-2022 АДАПТЕР ОЛИВ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Оливы конусообразные из оргстекла типоразмеров: диаметр 8мм, диаметр 11мм, диаметр 15мм, диаметр 20мм	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ОЛИВЫ КОНУСООБРАЗНЫЕ ИЗ ОРГСТЕКЛА ТИПОРАЗМЕРОВ: ДИАМЕТР 8ММ, ДИАМЕТР 11ММ, ДИАМЕТР 15ММ, ДИАМЕТР 20ММ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Оливы конусообразные металлические типоразмеров: диаметр 8мм, диаметр 11 мм, диаметр 15мм, диаметр 20мм	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ОЛИВЫ КОНУСООБРАЗНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТИПОРАЗМЕРОВ: ДИАМЕТР 8ММ, ДИАМЕТР 11ММ, ДИАМЕТР 15ММ, ДИАМЕТР 20ММ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Комплект для аспирации и промывания миндалин в составе: рукоятка, колпачок	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 КОМПЛЕКТ ДЛЯ АСПИРАЦИИ И ПРОМЫВАНИЯ МИНДАЛИН В СОСТАВЕ: РУКОЯТКА, КОЛПАЧОК   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Канюля для аспирации типоразмеров: диаметр 1,8 мм, диаметр 3 мм, диаметр 3,5 мм, диаметр 4 мм	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПИРАЦИИ ТИПОРАЗМЕРОВ: ДИАМЕТР 1,8 мм, ДИАМЕТР 3 мм, ДИАМЕТР 3,5 мм, ДИАМЕТР 4 мм   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Лоток для сброса использованных инструментов	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ЛОТОК ДЛЯ СБРОСА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Лоток из нержавеющей стали для инструментов	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ЛОТОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Лоток из нержавеющей стали для медицинских принадлежностей	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ЛОТОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Держатель пластиковый банок для лекарственных средств	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫЙ БАНОК ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Пистолет воздушный для использования с насадками-распылителями лекарственных средств без курка	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ПИСТОЛЕТ ВОЗДУШНЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С НАСАДКАМИ-РАСПЫЛИТЕЛЯМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ БЕЗ КУРКА   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Пистолет воздушный для использования с насадками-распылителями лекарственных средств с металлическим курком	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ПИСТОЛЕТ ВОЗДУШНЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С НАСАДКАМИ-РАСПЫЛИТЕЛЯМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КУРКОМ РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Пистолет воздушный для использования с насадками-распылителями лекарственных средств с пластиковым курком	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ПИСТОЛЕТ ВОЗДУШНЫЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С НАСАДКАМИ-РАСПЫЛИТЕЛЯМИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С ПЛАСТИКОВЫМ КУРКОМ РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Насадка-распылитель жидких лекарственных средств (изогнутая) для пистолета воздушного без курка	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ИЗОГНУТАЯ) ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ВОЗДУШНОГО БЕЗ КУРКА РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Насадка-распылитель жидких лекарственных средств (прямая) для пистолета воздушного без курка	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМАЯ) ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ВОЗДУШНОГО БЕЗ КУРКА   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Насадка-распылитель жидких лекарственных средств (изогнутая) для пистолета воздушного с металлическим курком	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ИЗОГНУТАЯ) ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ВОЗДУШНОГО С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КУРКОМ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Насадка-распылитель жидких лекарственных средств (прямая) для пистолета воздушного с металлическим курком	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМАЯ) ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ВОЗДУШНОГО С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КУРКОМ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Насадка-распылитель жидких лекарственных средств (изогнутая) для пистолета воздушного с пластиковым курком	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ИЗОГНУТАЯ) ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ВОЗДУШНОГО С ПЛАСТИКОВЫМ КУРКОМ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Насадка-распылитель жидких лекарственных средств (прямая) для пистолета воздушного с пластиковым курком	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМАЯ) ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ВОЗДУШНОГО С ПЛАСТИКОВЫМ КУРКОМ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Насадка-распылитель порошковых лекарственных средств (прямая) для пистолета воздушного без курка	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМАЯ) ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ВОЗДУШНОГО БЕЗ КУРКА   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Насадка-распылитель порошковых лекарственных средств (прямая) для пистолета воздушного с металлическим курком	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМАЯ) ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ВОЗДУШНОГО С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КУРКОМ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Насадка-распылитель порошковых лекарственных средств (прямая) для пистолета воздушного с пластиковым курком	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМАЯ) ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ВОЗДУШНОГО С ПЛАСТИКОВЫМ КУРКОМ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Насадка-распылитель маслянистых лекарственных средств (прямая) для пистолета воздушного без курка	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ МАСЛЯНИСТЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМАЯ) ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ВОЗДУШНОГО БЕЗ КУРКА   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Насадка-распылитель маслянистых лекарственных средств (прямая) для пистолета воздушного с металлическим курком	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ МАСЛЯНИСТЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМАЯ) ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ВОЗДУШНОГО С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КУРКОМ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Насадка-распылитель маслянистых лекарственных средств (прямая) для пистолета воздушного с пластиковым курком	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ МАСЛЯНИСТЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМАЯ) ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ВОЗДУШНОГО С ПЛАСТИКОВЫМ КУРКОМ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Емкость для лекарственных средств для пистолета воздушного без курка объемом 30мл	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ВОЗДУШНОГО БЕЗ КУРКА ОБЪЕМОМ 30МЛ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Емкость для лекарственных средств для пистолета воздушного с пластиковым курком объемом 30мл	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ВОЗДУШНОГО С ПЛАСТИКОВЫМ КУРКОМ ОБЪЕМОМ 30МЛ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Емкость для лекарственных средств для пистолета воздушного с металлическим курком объемом 60мл	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ВОЗДУШНОГО С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КУРКОМ ОБЪЕМОМ 60МЛ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Тюльпан для промывания уха	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ТЮЛЬПАН ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ УХА   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Кресло пациента электромеханическое	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 КРЕСЛО ПАЦИЕНТА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ    СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА: (230±23)В ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ:185ВА ЧАСТОТА СЕТИ:50Гц   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ,СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Блок управления эндоскопической визуализации DS.VISION FHD 3IN1 АДАПТЕР ПИТАНИЯ	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ DS.VISION FHD 3IN1 АДАПТЕР ПИТАНИЯ     ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА: 100-240В ЧАСТОТА ПИТАНИЯ: 50/60Гц Iном: 1,4А ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: ПОСТОЯННЫЙ ТОК: 12В Iном:0,5А РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ,СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru IPX0
Блок управления эндоскопической визуализации DS.VISION FHD 3IN1 АДАПТЕР ЭНДОСКОПА	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ DS.VISION FHD 3IN1 АДАПТЕР ЭНДОСКОПА    РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ,СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Блок управления эндоскопической визуализации DS.VISION FHD 3IN1 ИСТОЧНИК СВЕТА	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ DS.VISION FHD 3IN1 ИСТОЧНИК СВЕТА    РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Блок управления эндоскопической визуализации DS.VISION FHD 3IN1 КАМЕРА	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ DS.VISION FHD 3IN1 КАМЕРА    РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Блок управления эндоскопической визуализации DS.VISION FHD 3IN1	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ DS.VISION FHD 3IN1     ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: (230±23)В ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 60ВА РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Насадка- сопло для впрыскивания воды под давлением	 УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 НАСАДКА-СОПЛО ДЛЯ ВПРЫСКИВАНИЯ ВОДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ,СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Блок управления эндоскопической визуализации DS.VISION FHD ВИДЕОМОНИТОР	 УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ DS.Vision FHD ВИДЕОМОНИТОР      РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ,СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Блок управления эндоскопической визуализации DS.VISION FHD ИСТОЧНИК СВЕТА	 УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ DS.Vision FHD ИСТОЧНИК СВЕТА     РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ,СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Блок управления эндоскопической визуализации DS.VISION FHD КАМЕРА	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ DS.Vision FHD КАМЕРА     РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Блок управления эндоскопической визуализации DS.VISION FHD	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ DS.Vision FHD      СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА: 100-240В ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 45ВА ЧАСТОТА СЕТИ: 50/60Гц РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Защита от брызг	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Источник света DS.Vision LIGHT с фиброкабелем	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ИСТОЧНИК СВЕТА DS.Vision LIGHT с ФИБРОКАБЕЛЕМ   СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА: (230±23)В ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 85ВА ЧАСТОТА СЕТИ: 50Гц    РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Резервуар для системы промывания полостей объемом 2 л	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СИСТЕМЫ ПРОМЫВАНИЯ ПОЛОСТЕЙ ОБЪЕМОМ 2 Л  РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Кабель соединительный для блока управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD 3in1	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ DS.Vision FHD 3in1  РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Кабель соединительный для блока управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ DS.Vision FHD   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Кабель соединительный для источника света DS.Vision LIGHT с фиброкабелем	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ИСТОЧНИКА СВЕТА DS.Vision Light с ФИБРОКАБЕЛЕМ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Кабель соединительный для кресла пациента электромеханического	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ КРЕСЛА ПАЦИЕНТА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Кабель питания для кресла пациента электромеханического	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ДЛЯ КРЕСЛА ПАЦИЕНТА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Педальный выключатель	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ПЕДАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru IP26
Кабель DVI	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 КАБЕЛЬ DVI   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Кабель CVBS	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 КАБЕЛЬ CVBS   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Кабель HDMI	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 КАБЕЛЬ HDMI   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Кабель SDI	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 КАБЕЛЬ SDI   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Стойка приборная DS.T-4-04	 УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 СТОЙКА ПРИБОРНАЯ DS.T-4-04   СЕТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА: (230±23)В ЧАСТОТА СЕТИ: 50Гц  РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
---------------------------------------	--

Кронштейн крепления штанги из алюминия к установке *	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ ИЗ АЛЮМИНИЯ К УСТАНОВКЕ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Кронштейн крепления штанги из стали к установке	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ШТАНГИ ИЗ СТАЛИ К УСТАНОВКЕ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Полка для дополнительного оборудования	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ПОЛКА ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Кронштейн крепления полки для дополнительного оборудования	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПОЛКИ для дополнительного оборудования   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Кронштейн для крепления монитора	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 КРОНШТЕЙН для КРЕПЛЕНИЯ МОНИТОРА   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Держатель VESA для монитора или видеосистемы	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ДЕРЖАТЕЛЬ VESA для МОНИТОРА ИЛИ ВИДЕОСИСТЕМЫ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

ds.MEDУСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.Assistent
по ТУ 32.50.50-002-06671063-2022**СТУЛ ВРАЧА**

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1.
Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru**ds.MED**УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.Assistent
по ТУ 32.50.50-002-06671063-2022**ПОЛКА С ЧЕТЫРЬМЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ БАНКАМИ
ОБЪЕМОМ 350МЛ
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1.
Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru**ds.MED**УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.Assistent
по ТУ 32.50.50-002-06671063-2022**БАНОЧКА ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
С ПРИТЕРТОЙ КРЫШКОЙ ОБЪЕМОМ 30МЛ**

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1.
Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru**Стул врача****Полка с четырьмя
металлическими банками
объемом 350мл для
инструментов и
лекарственных средств****Баночка для
лекарственных средств
с притертой крышкой
объемом 30мл**

Полка с пятью лотками металлических для инструментов	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.Assistent по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ПОЛКА С ПЯТЬЮ ЛОТКАМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 1432114, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(496)3301185 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Полка с четырьмя банками объемом 350 мл для инструментов и лекарственных средств с посадочным местом для держателей эндоскопов	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.Assistent по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ПОЛКА С ЧЕТЫРЬМЯ БАНКАМИ ОБЪЕМОМ 350МЛ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С ПОСАДОЧНЫМ МЕСТОМ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЭНДОСКОПОВ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 1432114, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(496)3301185 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Держатель жестких эндоскопов металлический	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.Assistent по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕСТКИХ ЭНДОСКОПОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 1432114, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(496)3301185 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Держатель гибких эндоскопов металлический	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.Assistent по ТУ 32.50.50-002-00671063-2022 ДЕРЖАТЕЛЬ ГИБКИХ ЭНДОСКОПОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Держатель камеры	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.Assistent по ТУ 32.50.50-002-00671063-2022 ДЕРЖАТЕЛЬ КАМЕРЫ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru
Кронштейн крепления налобного фонаря	ds.MED УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.Assistent по ТУ 32.50.50-002-00671063-2022 КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ НАЛОБНОГО ФОНАРЯ   РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1. Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Поверхность
рабочая для врача



УСТАНОВКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ DS.AssistENT
по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022

ПОВЕРХНОСТЬ РАБОЧАЯ ДЛЯ ВРАЧА



РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО ДС.МЕД, 142214, МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. О.СЕРПУХОВ, Г. СЕРПУХОВ, СЕВЕРНЫЙ ПР-Д, д. 6, ОФИС 1.
Тел.: +7(495)2301155 www.ds-med.ru info@ds-med.ru

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

29 (двадцать девять) листов
цифрами прописью

Должность инженер

Подпись Степанов / Голованов

«29» сентября 2023 г. М.П.




УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ДС.Мед»

Е.И. Сёмочкин




29 сентября 2023 г.

**Фотографические изображения составных частей и принадлежностей
Установки оториноларингологической DS.AssistENT
по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022
в вариантах исполнения:
(редакция 02)**

Установка оториноларингологическая DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 вариант исполнения Basic, вид спереди



Установка оториноларингологическая L.S.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 вариант исполнения Basic, вид сзади

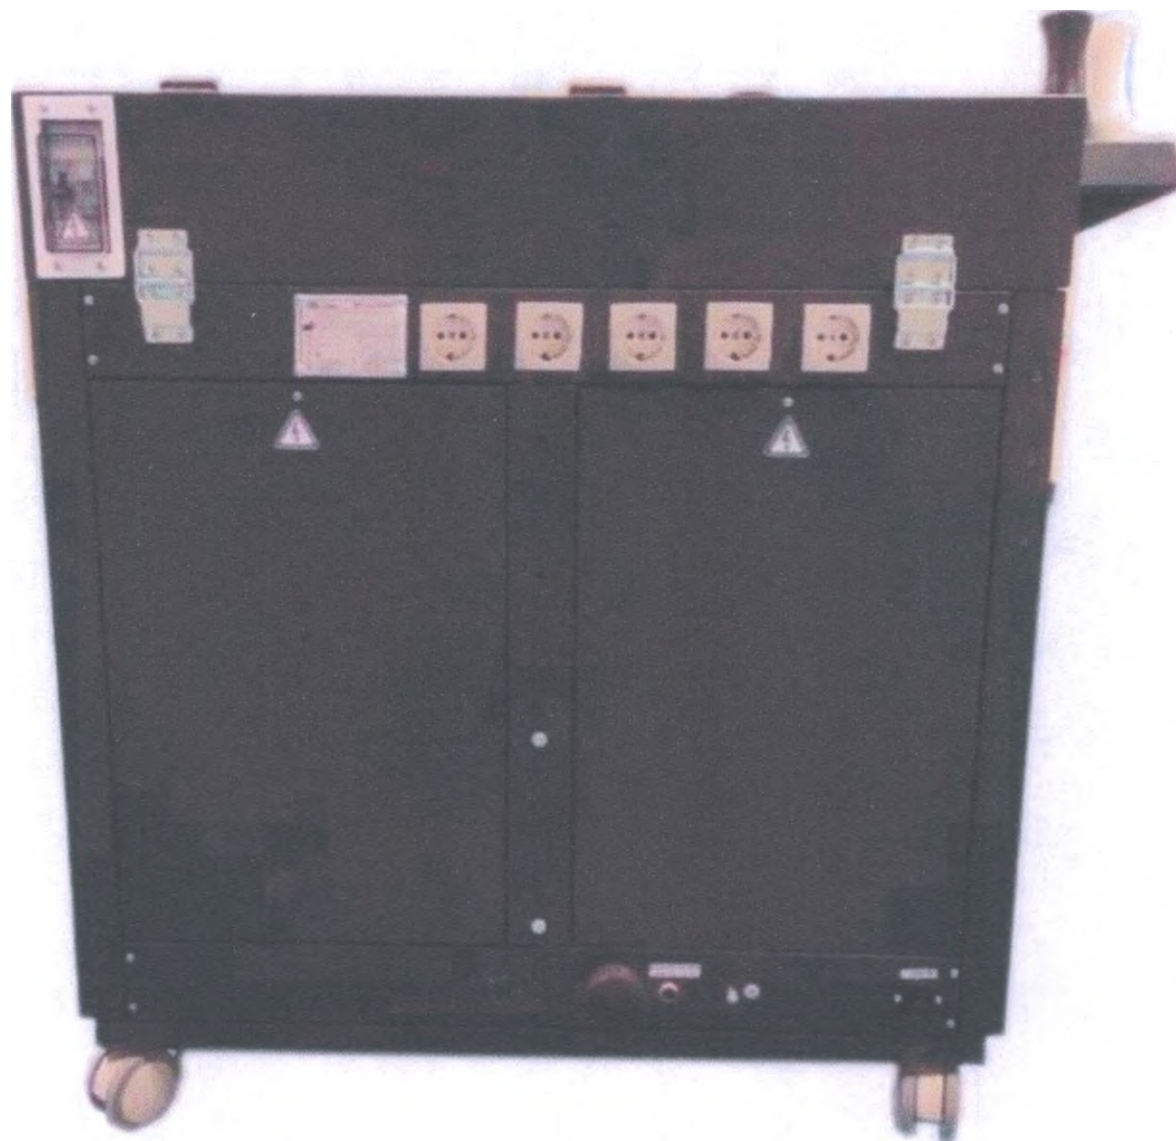





Установка оториноларингологическая DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 вариант исполнения Basic, вариант исполнения с дополнительными опциями



Шнур сетевого питания

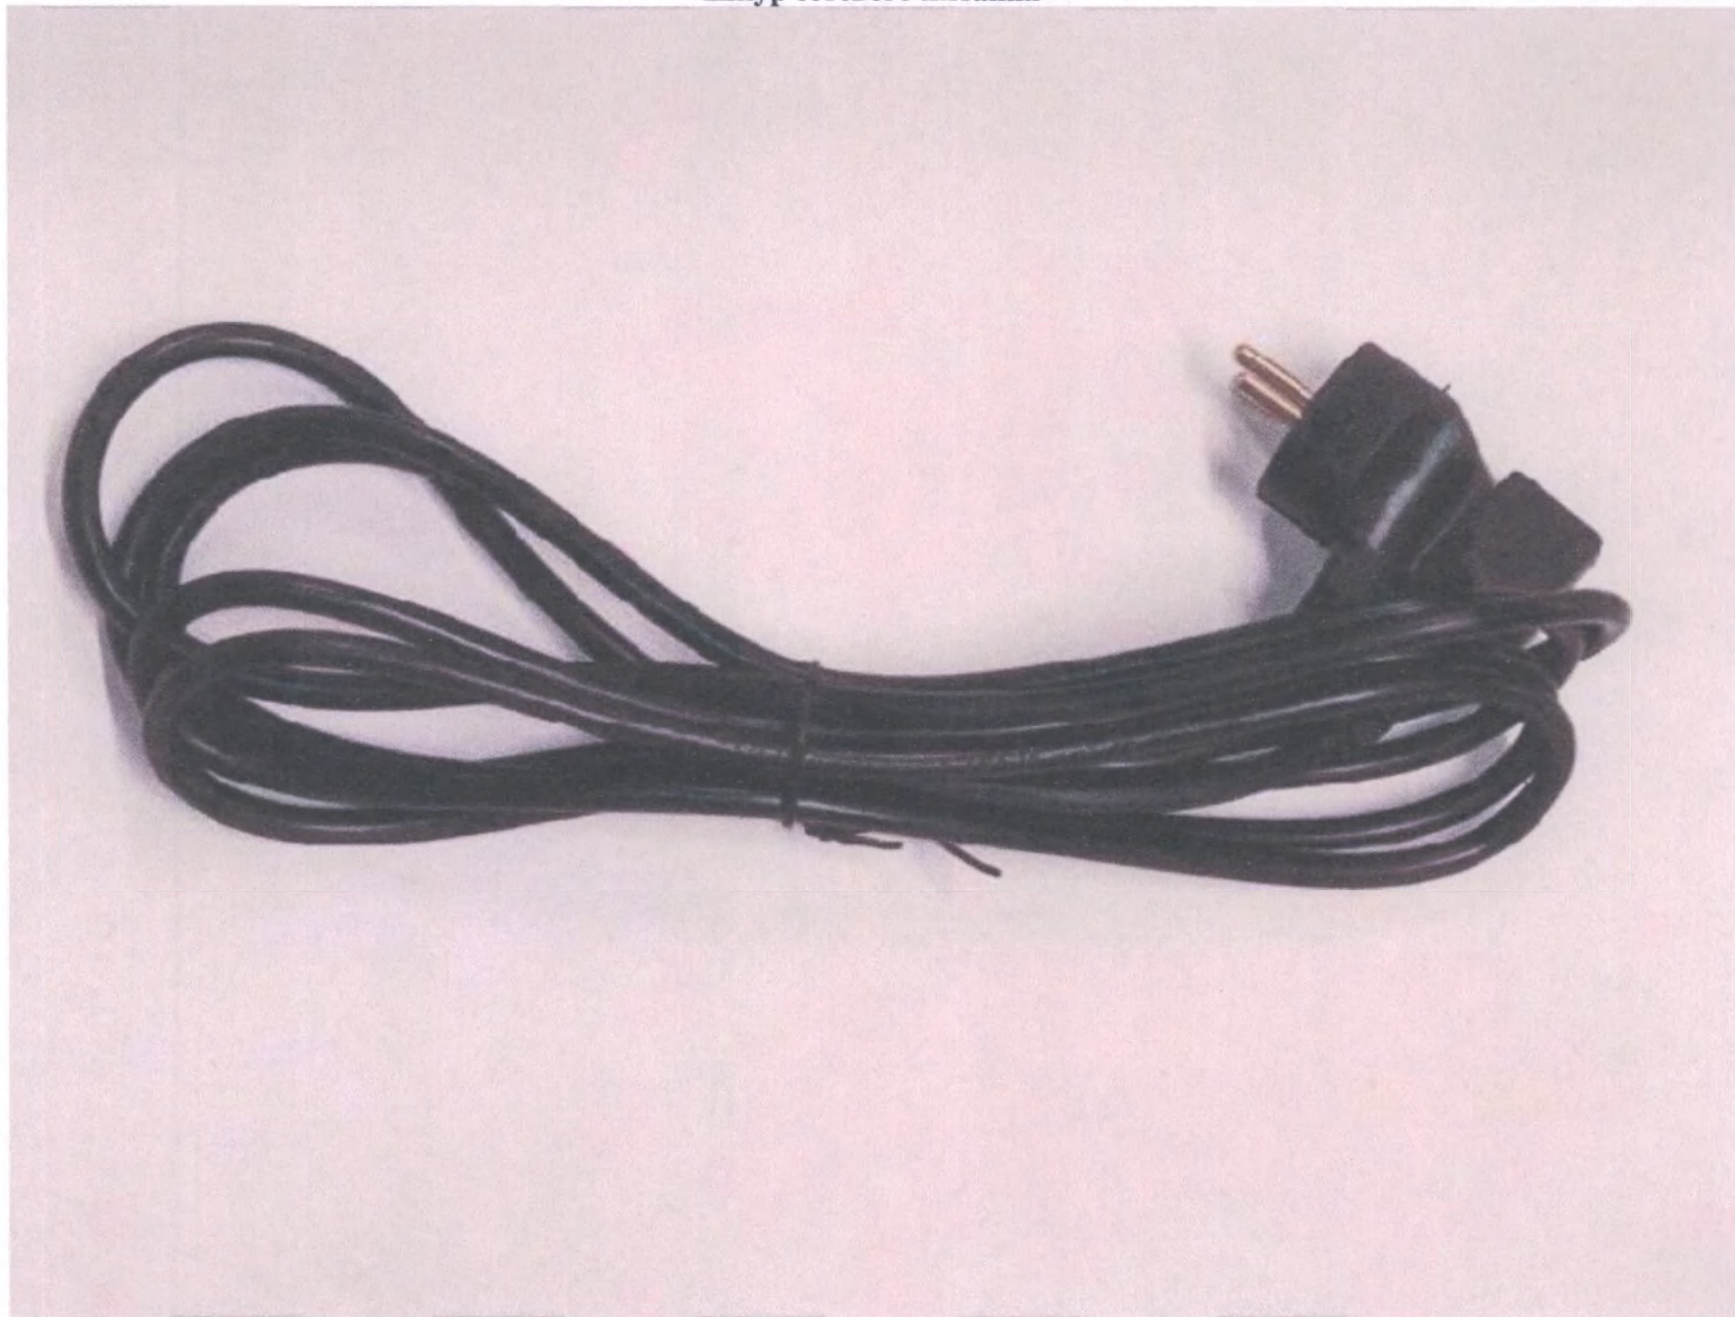

Стакан пластиковый для временного хранения чистых жестких эндоскопов

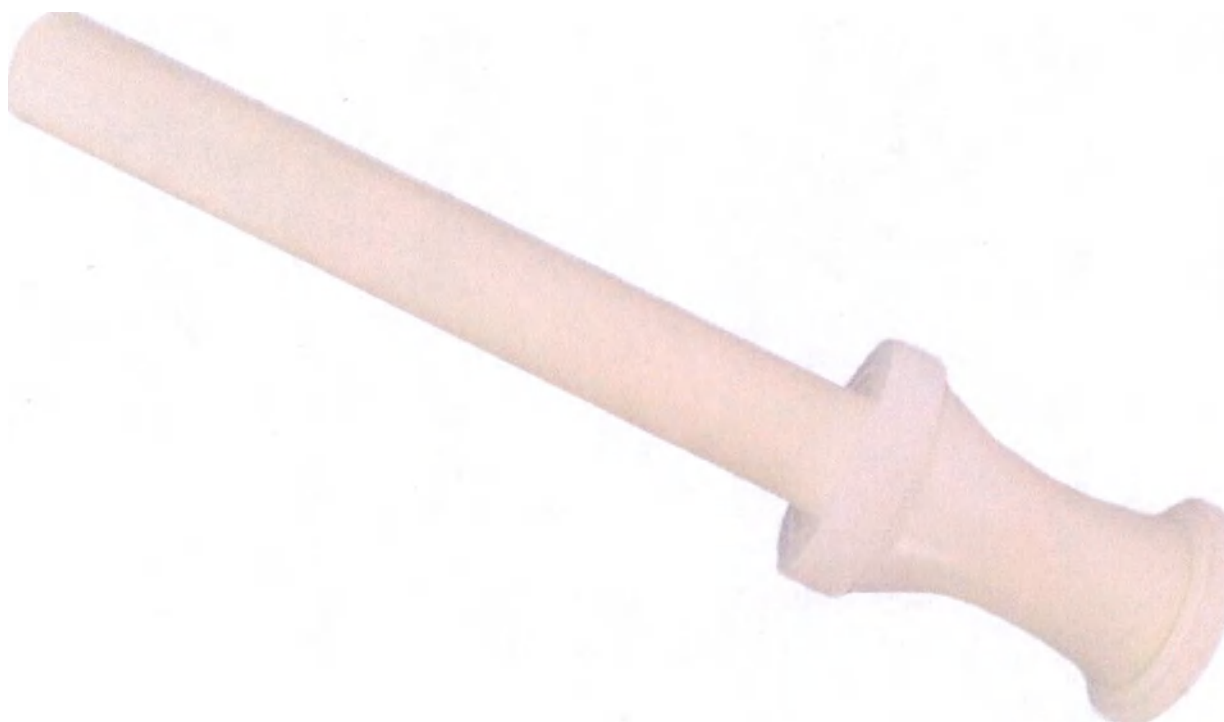


Стакан пластиковый для временного хранения использованных жестких эндоскопов



Стакан пластиковый для временного хранения чистых гибких эндоскопов



Стакан пластиковый для временного хранения использованных гибких эндоскопов

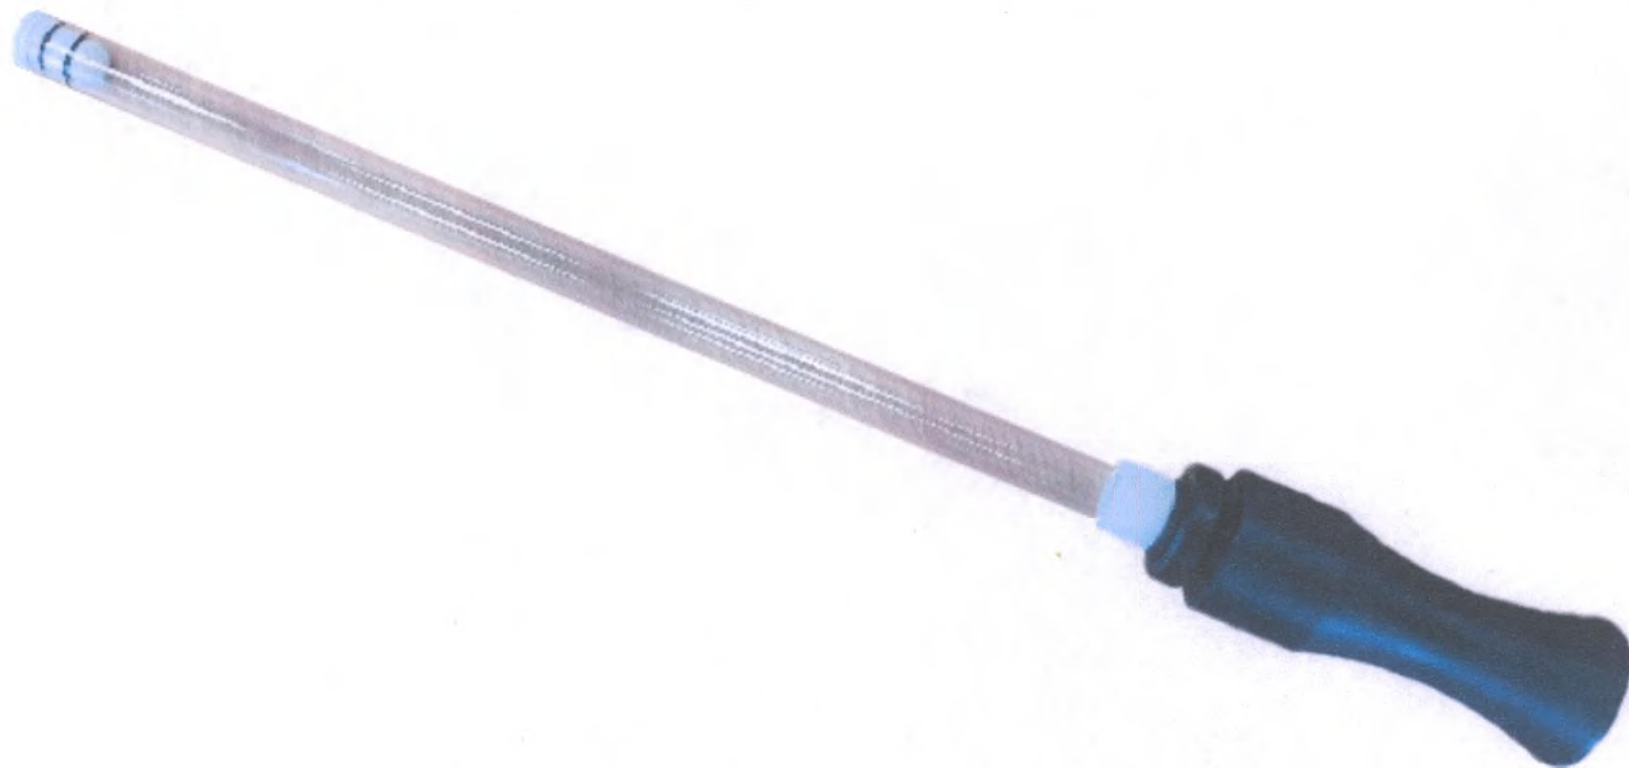

1. Емкость накопительная для секрета




2. Емкость накопительная для секрета




Адаптер олив



Оливы конусообразные из оргстекла типоразмеров: диаметр 8 мм, диаметр 11 мм, диаметр 15 мм, диаметр 20 мм

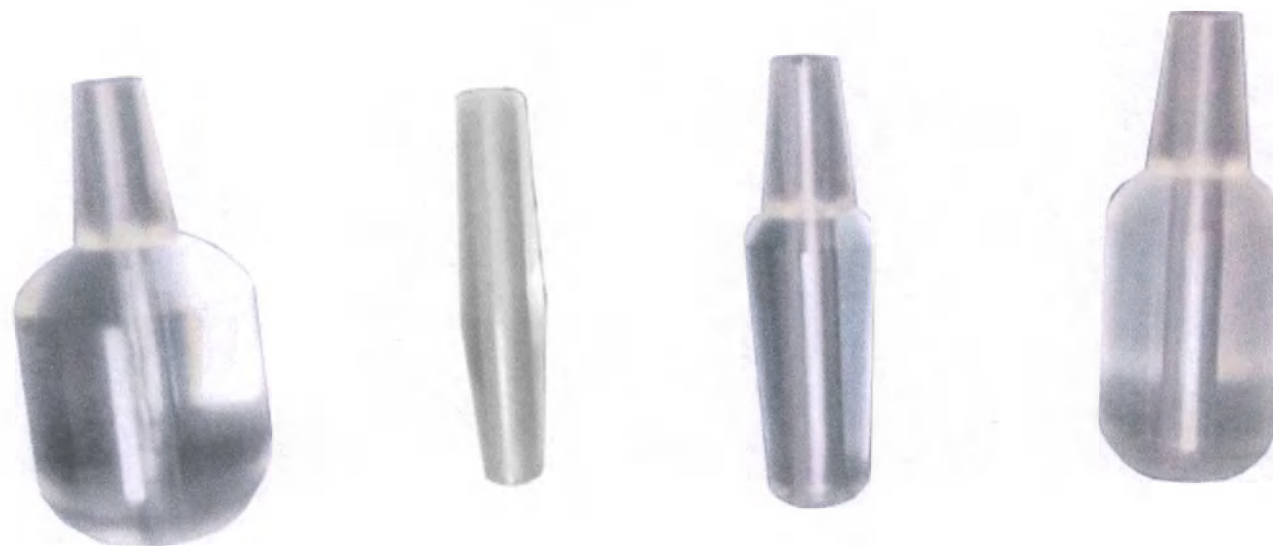


Оливы конусообразные металлические типоразмеров: диаметр 8 мм, диаметр 1 мм, диаметр 15 мм, диаметр 20 мм

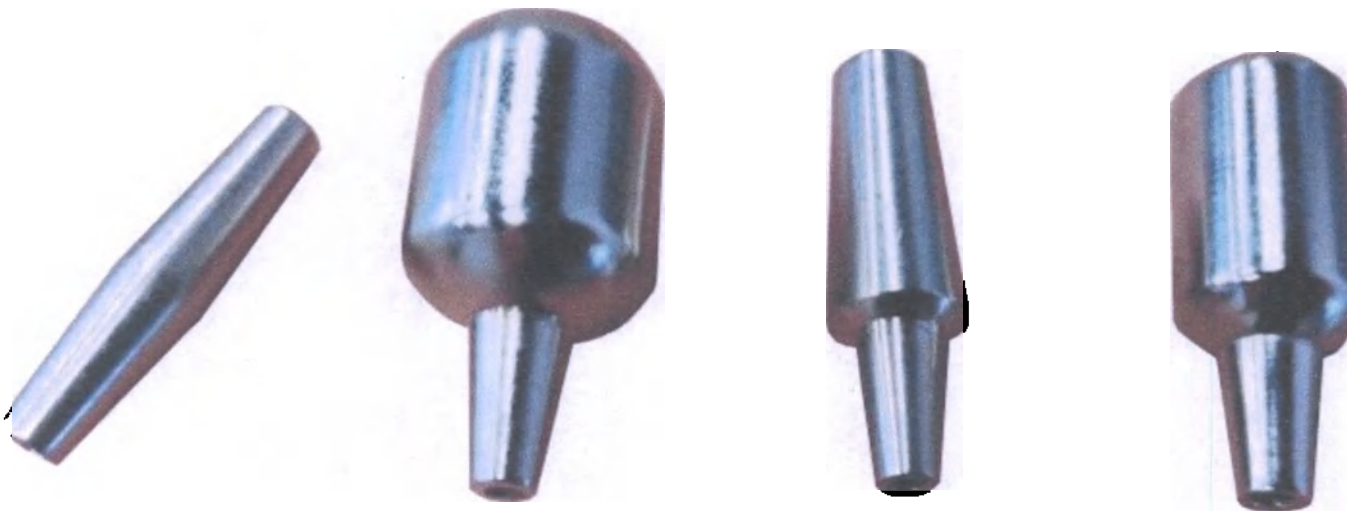


Комплект для аспирации и промывания миндалин в составе: рукоятка, колпачек



Канюля для аспирации типоразмеров: диаметр 1,8 мм, диаметр 3 мм, диаметр 3,5 мм, диаметр 4 мм

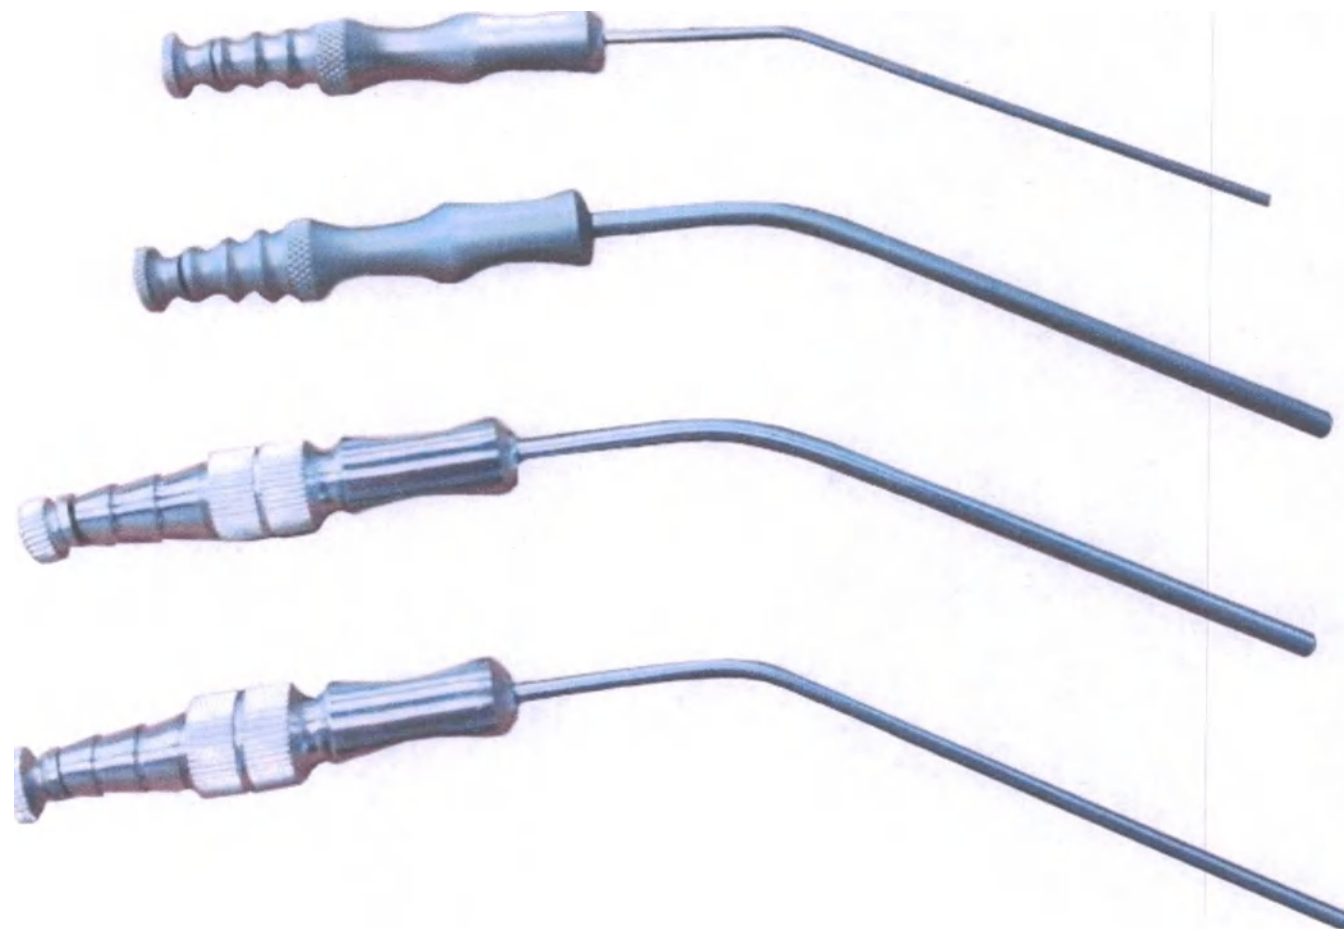

Лоток для сброса использованных инструментов

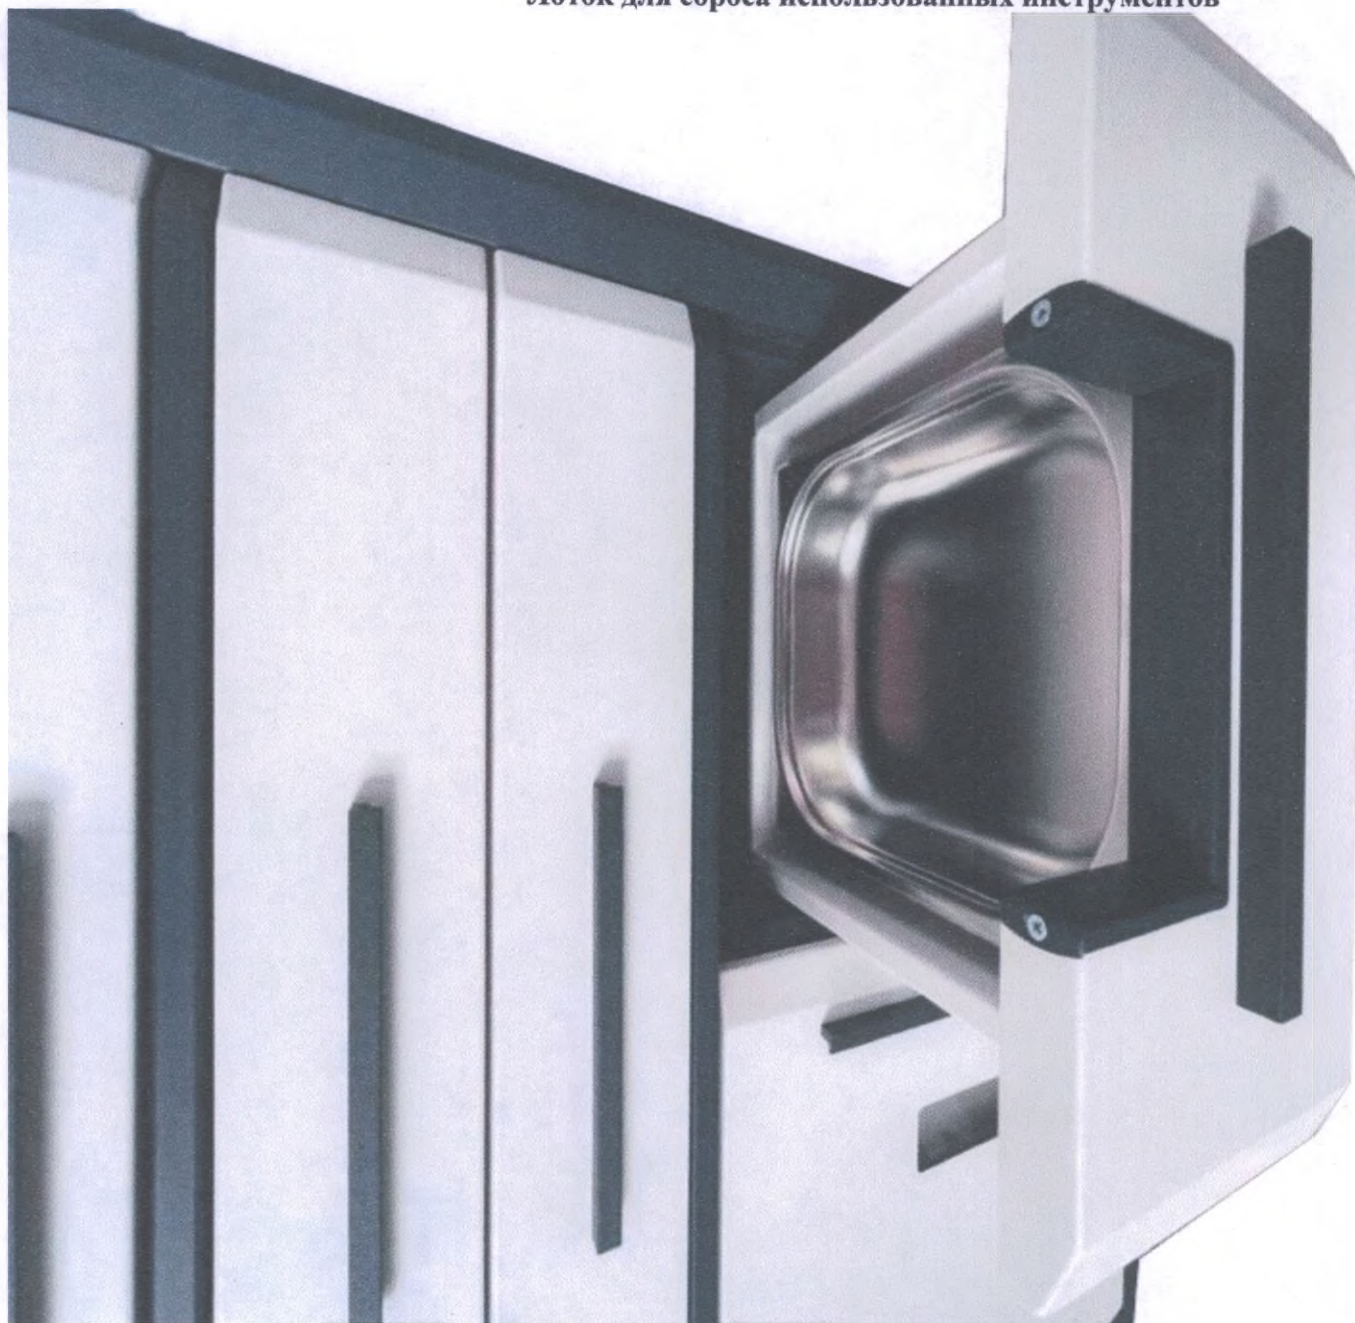


Лоток из нержавеющей стали для инструментов




Лоток из нержавеющей стали для медицинских принадлежностей




Держатель пластиковый банок для лекарственных средств

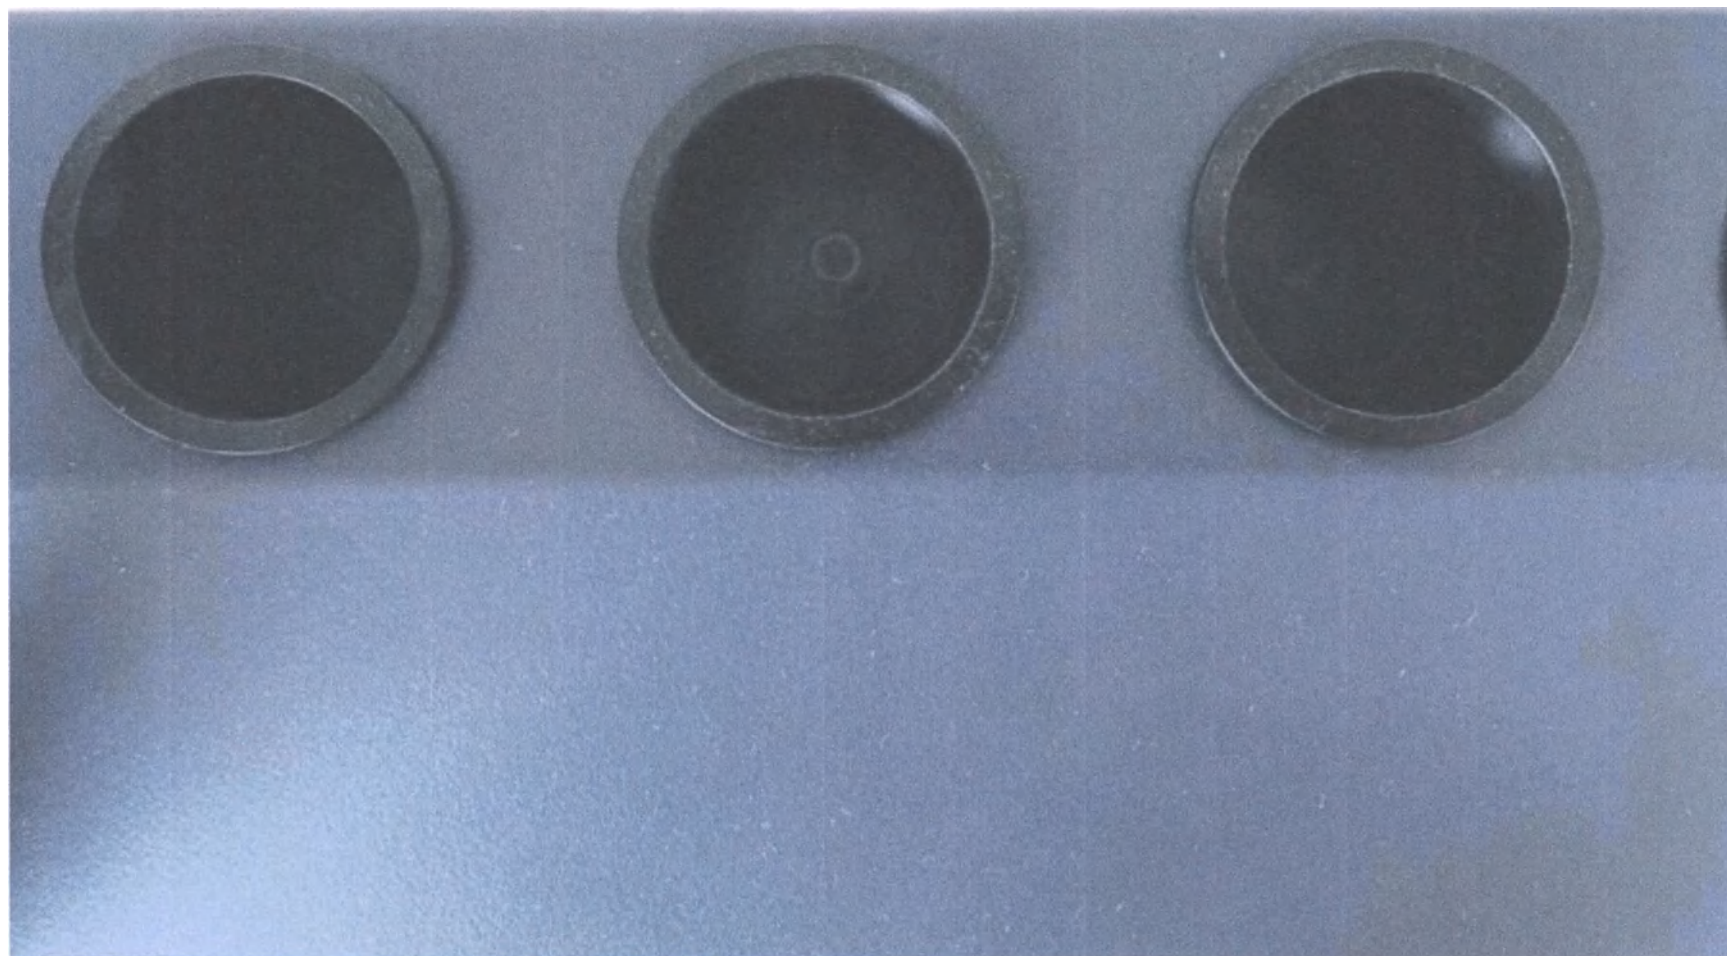

Пистолет воздушный для использования с насадками-распылителями лекарственных средств: с пластиковым курком

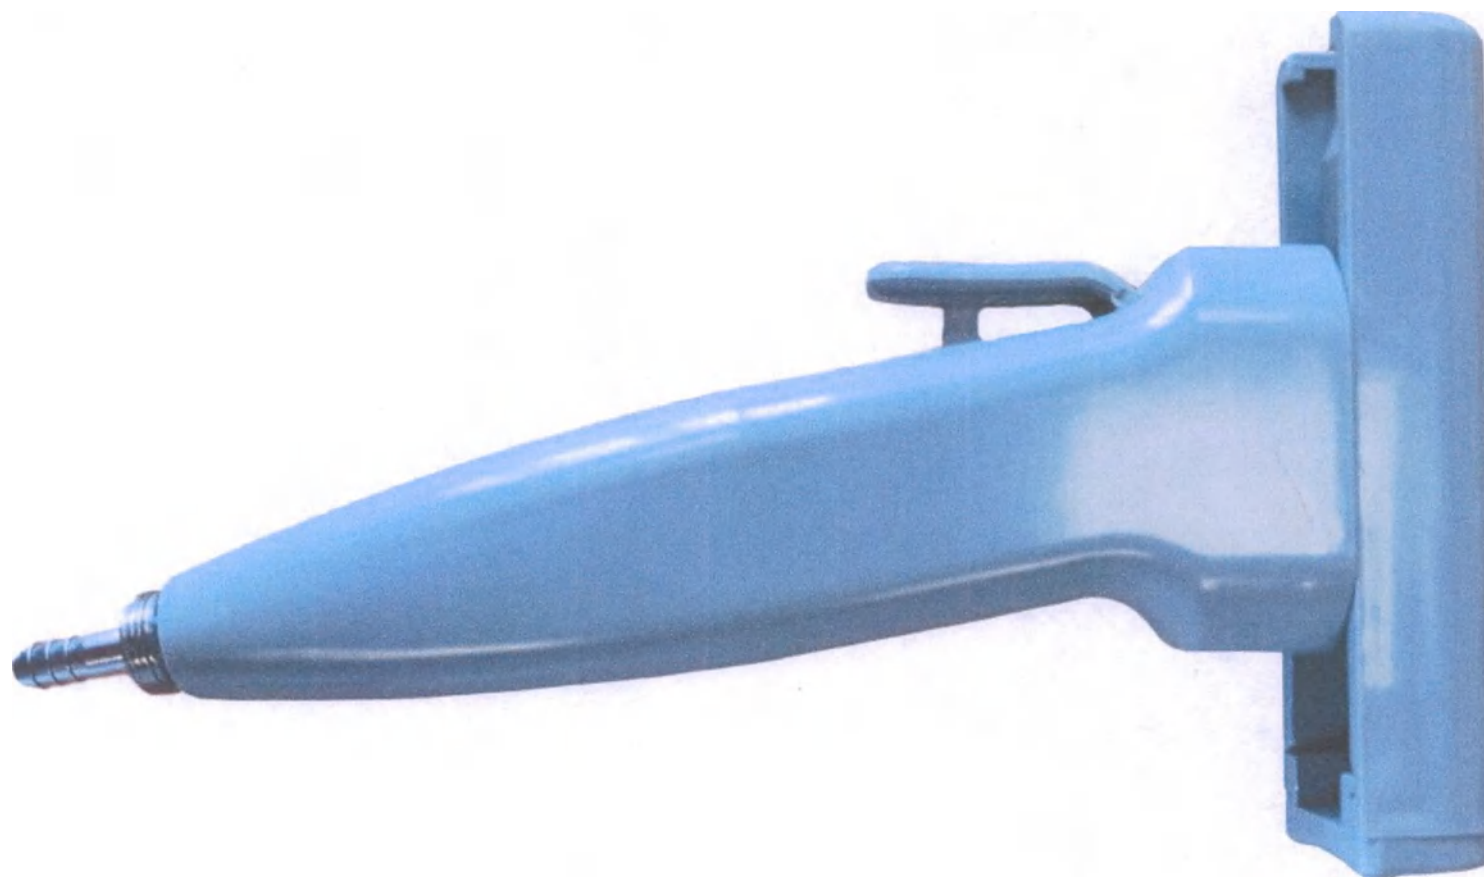


Пистолет воздушный для использования с насадками-распылителями лекарственных средств: с металлическим курком

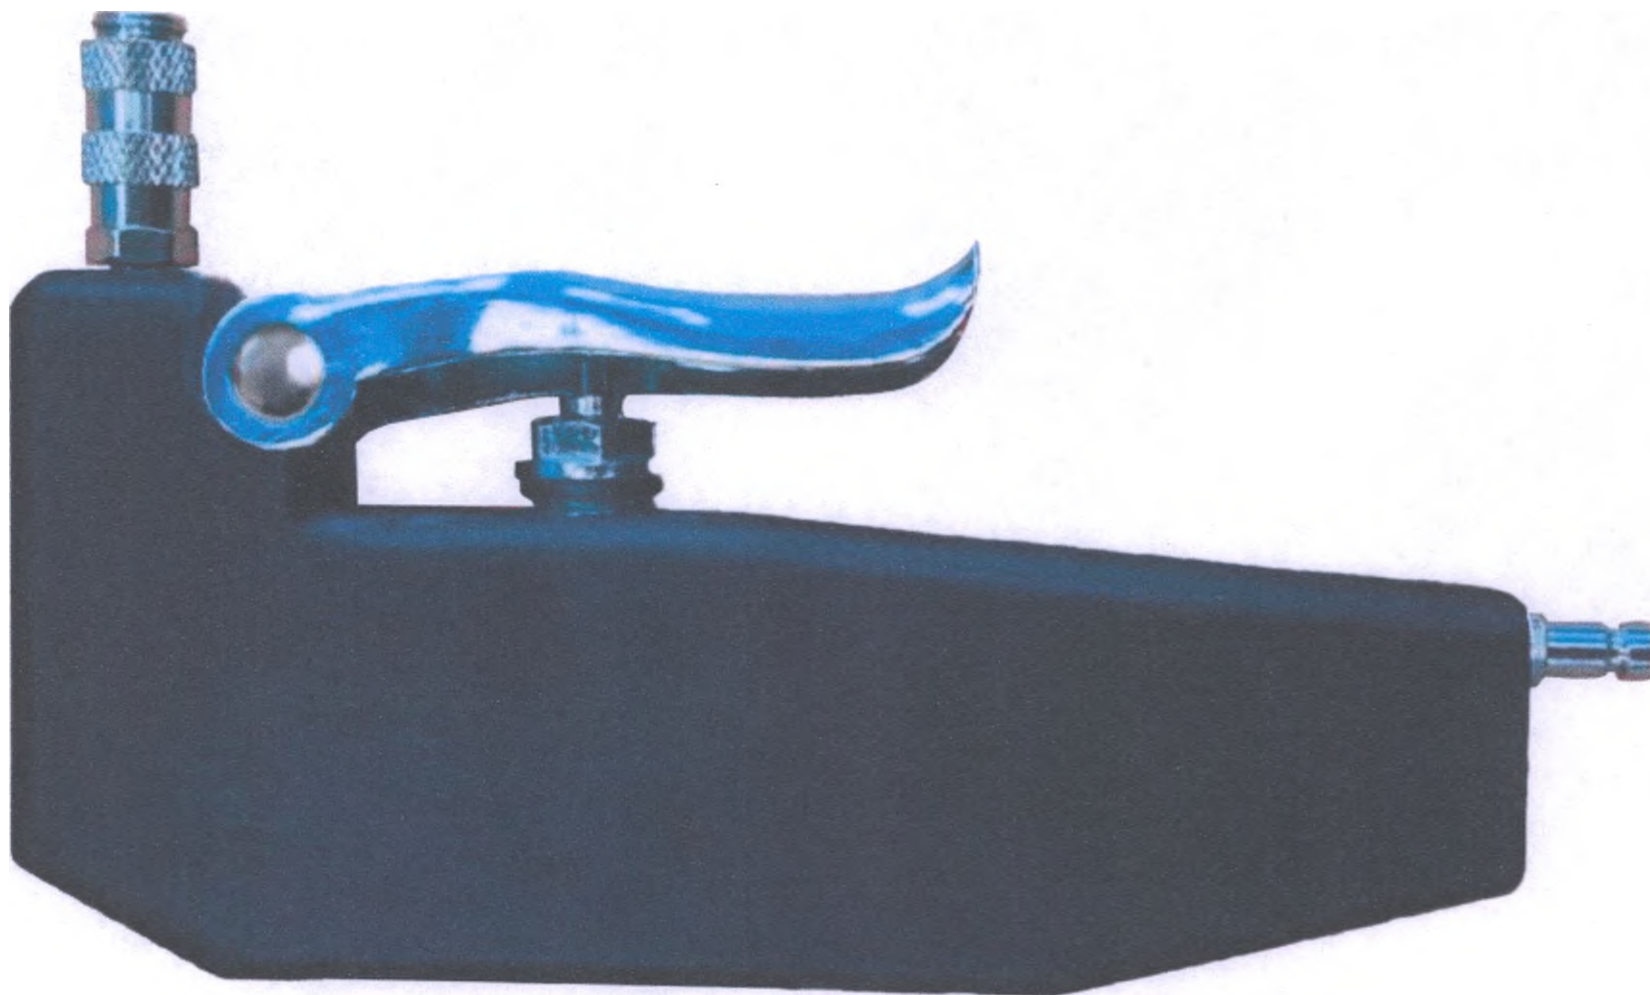


Пистолет воздушный для использования с насадками-распылителями лекарственных средств: без курка




Насадка-распылитель жидких лекарственных средств (прямая) : для пистолета воздушного с пластиковым курком

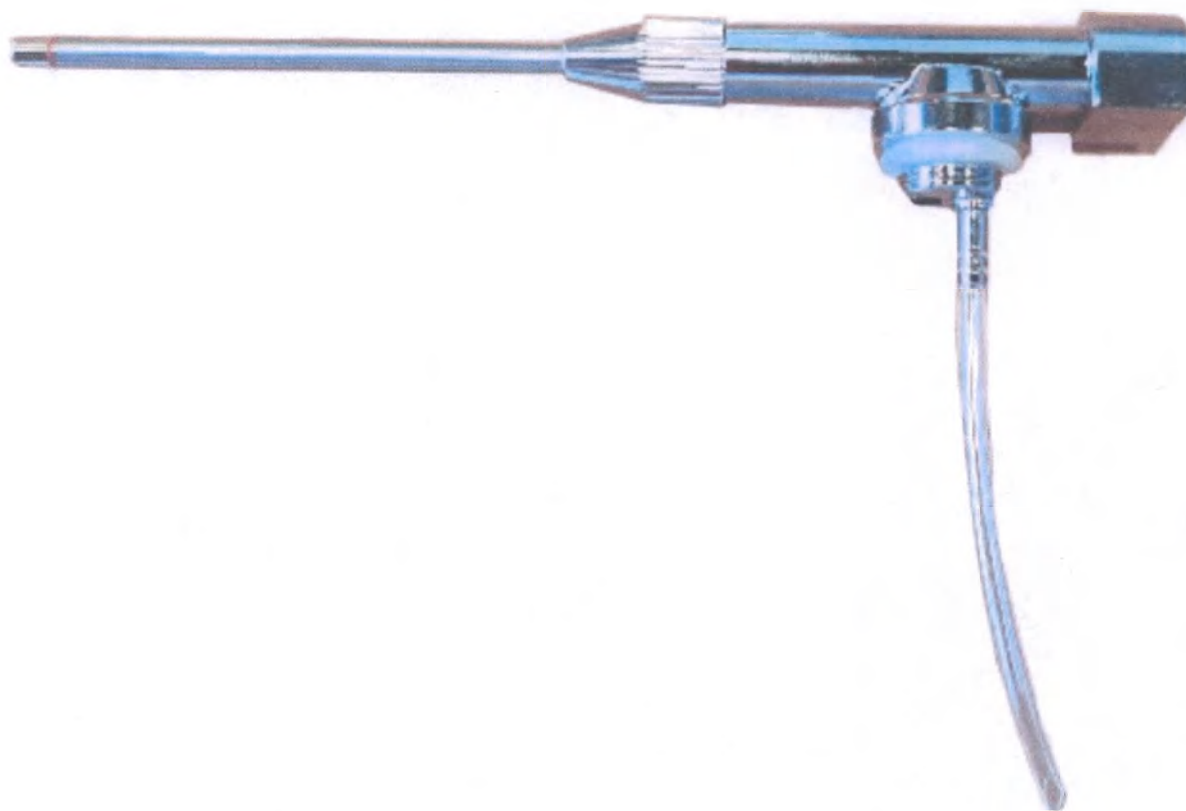

Насадка-распылитель жидких лекарственных средств (прямая) : для пистолета воздушного с металлическим курком

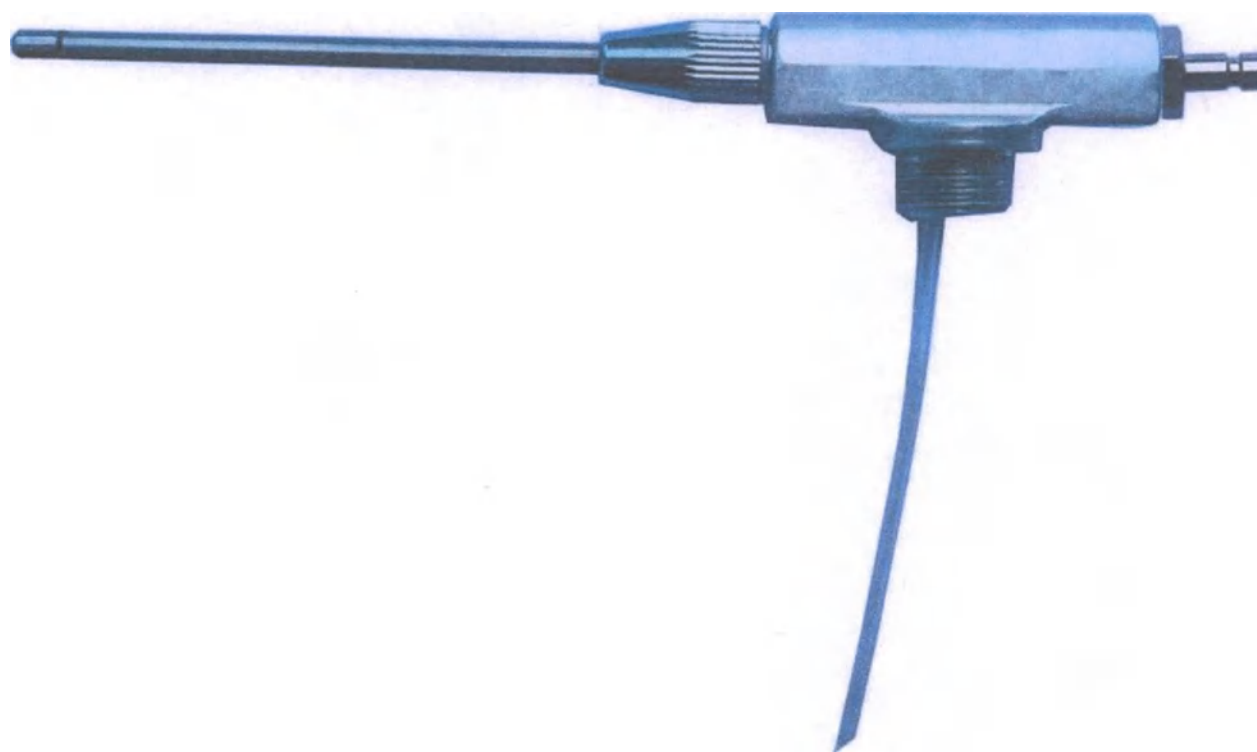


Насадка-распылитель жидких лекарственных средств (прямая) : для пистолета воздушного без курка

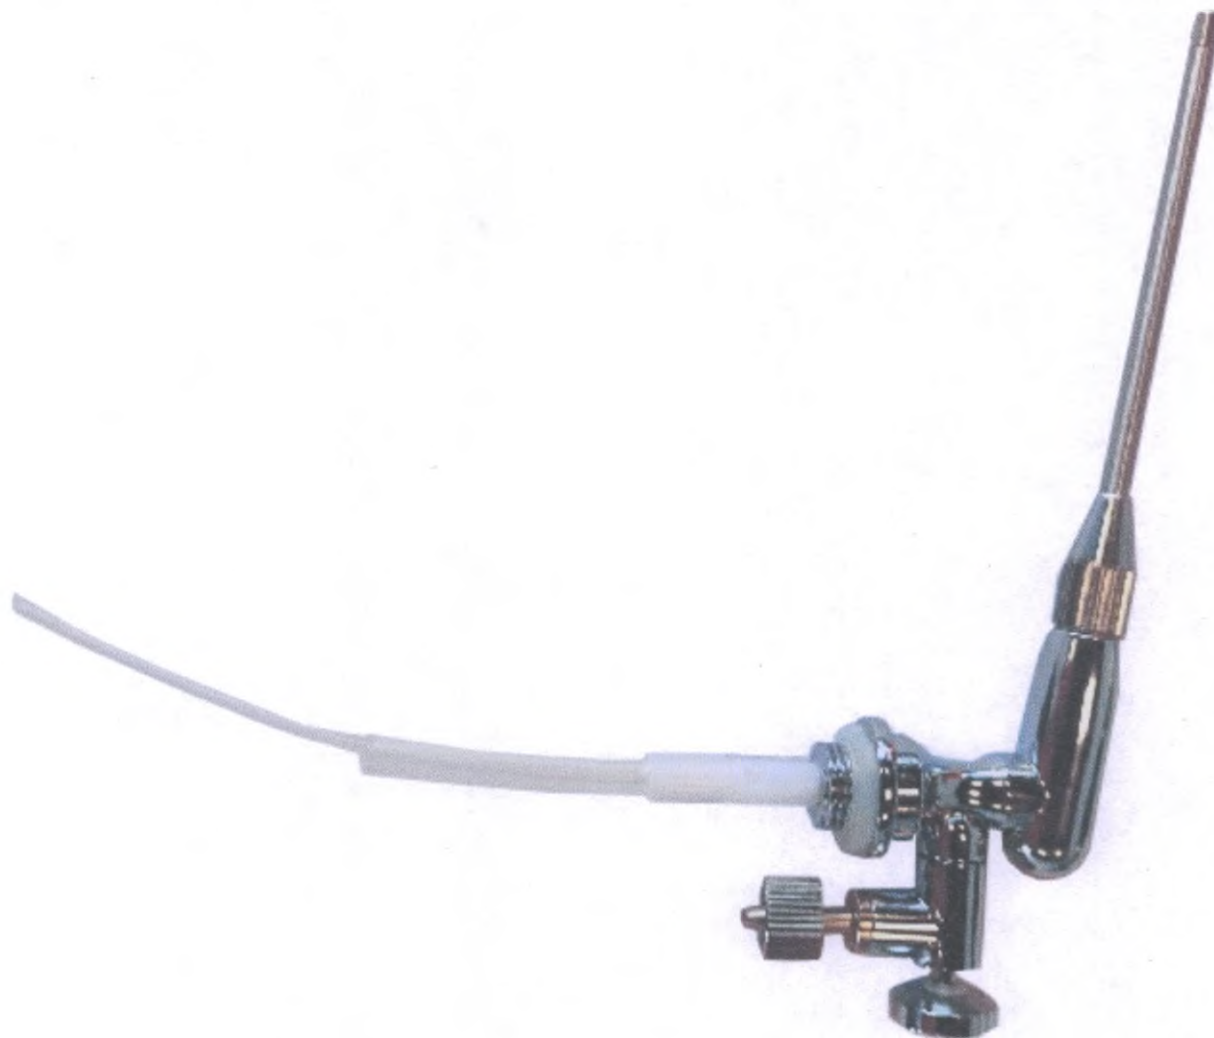


Насадка - распылитель жидких лекарственных средств (изогнутая): для пистолета воздушного с пластиковым курком




Насадка - распылитель жидких лекарственных средств (изогнутая): для пистолета воздушного с металлическим курком

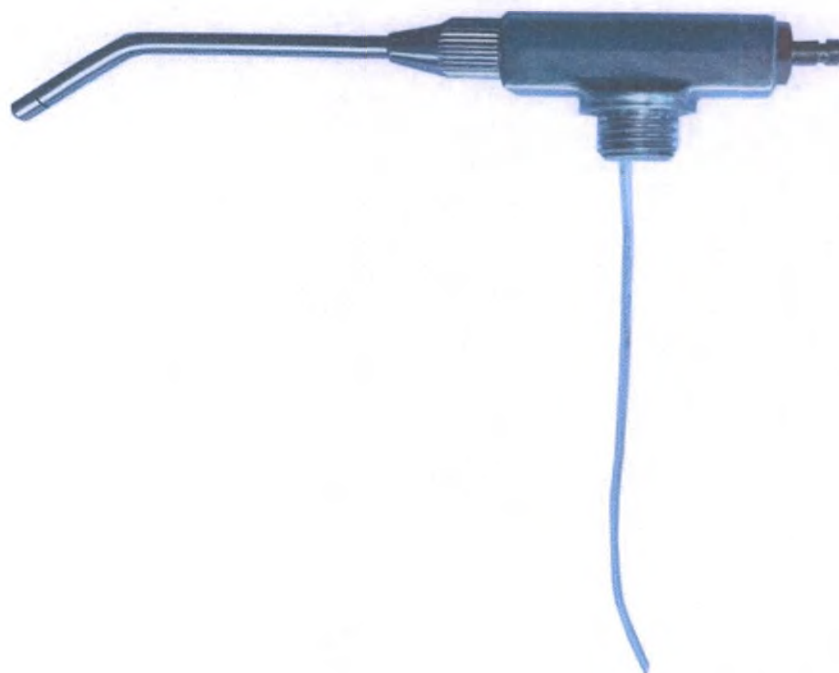


Насадка - распылитель жидких лекарственных средств (изогнутая): для пистолета воздушного без курка

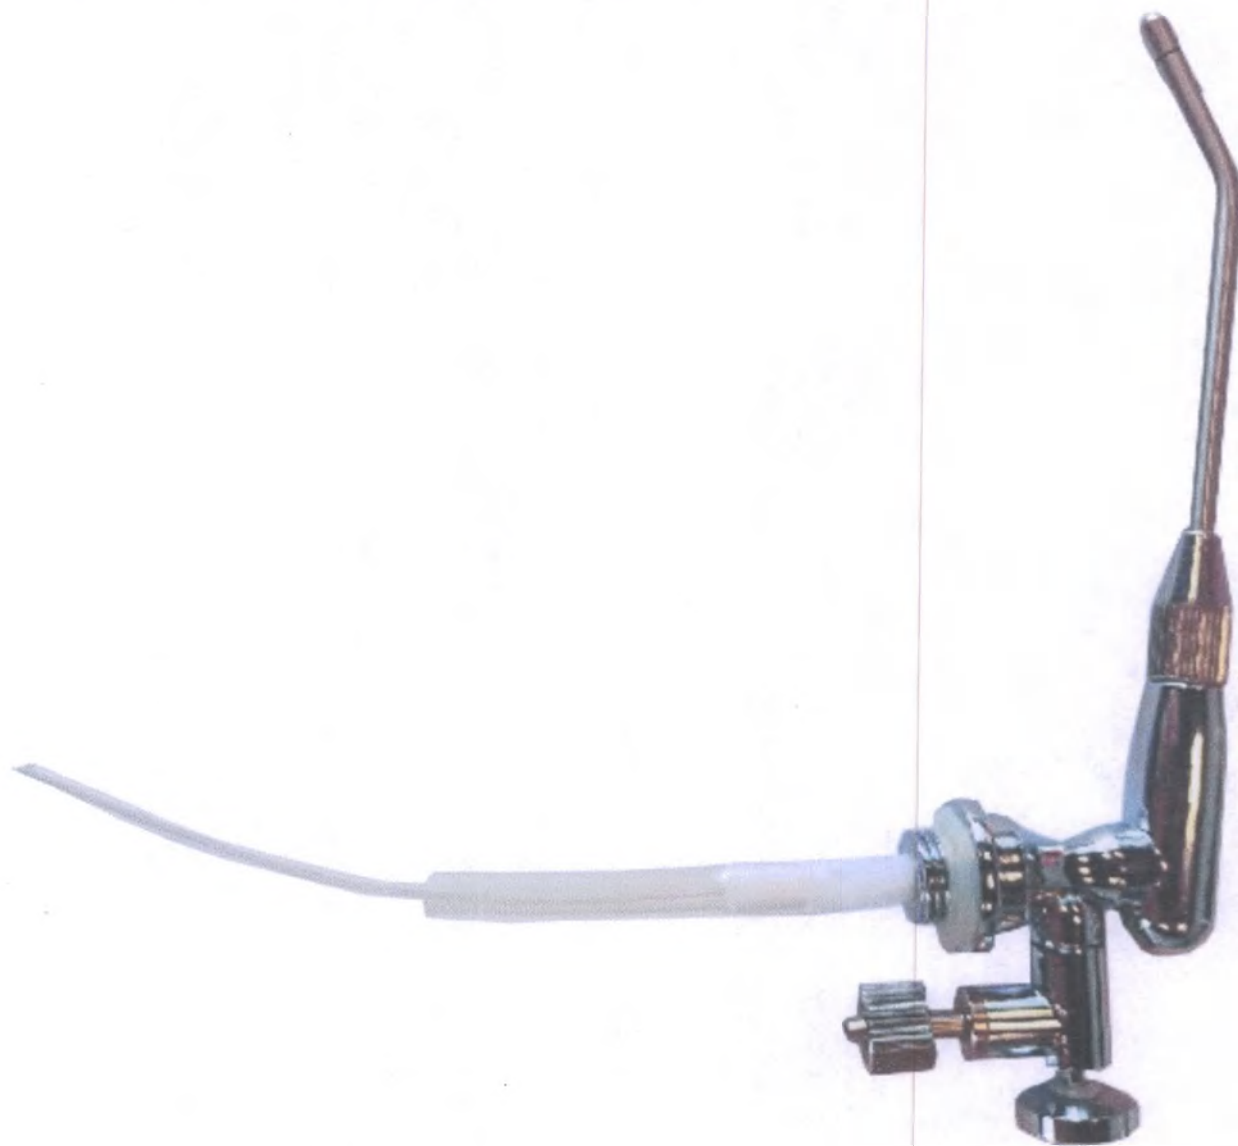


Насадка - распылитель маслянистых лекарственных средств (прямая): для пистолета воздушного с пластиковым курком

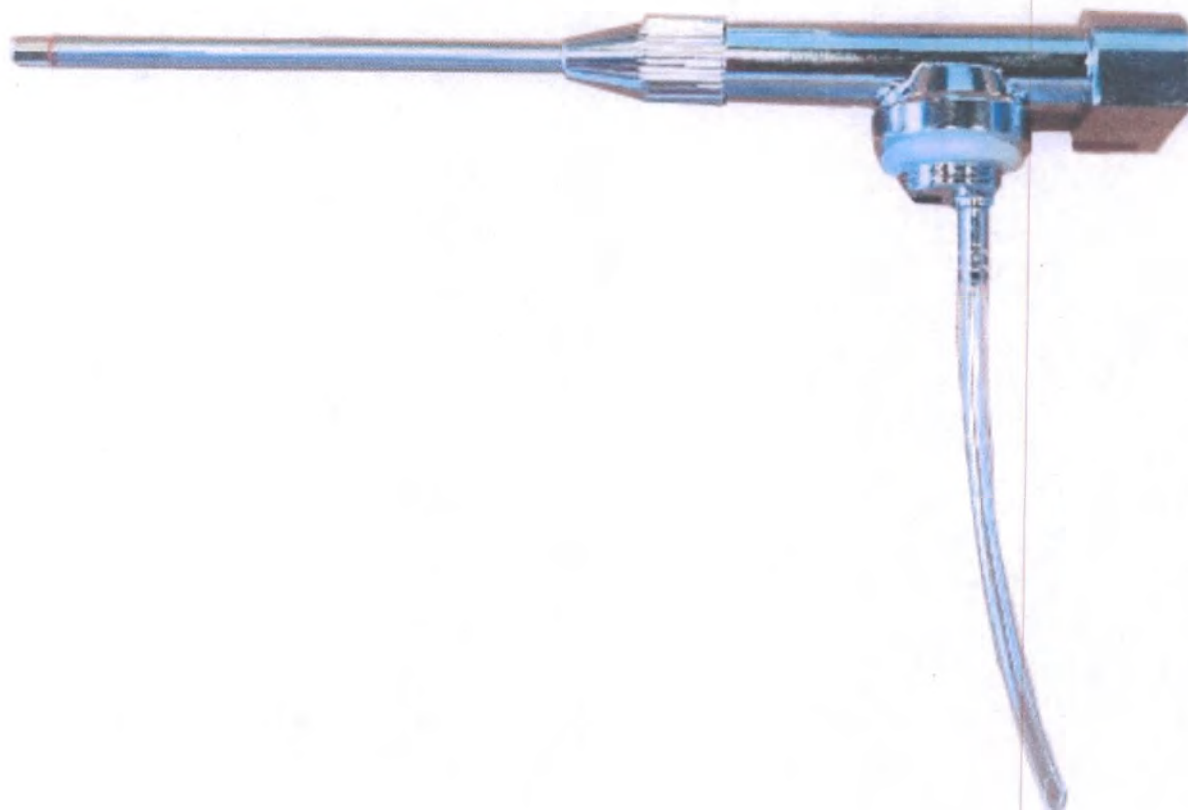


Насадка - распылитель маслянистых лекарственных средств (прямая): для пистолета воздушного с металлическим курком

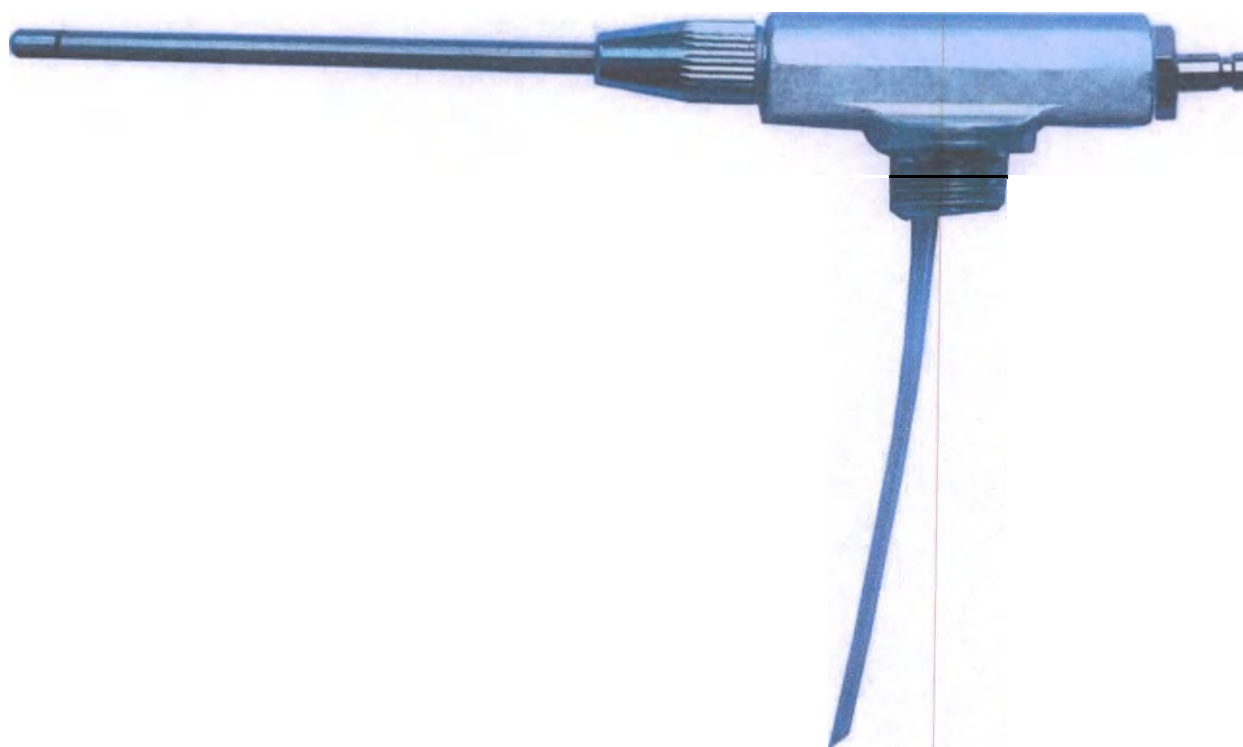


Насадка - распылитель маслянистых лекарственных средств (прямая): для пистолета воздушного без курка

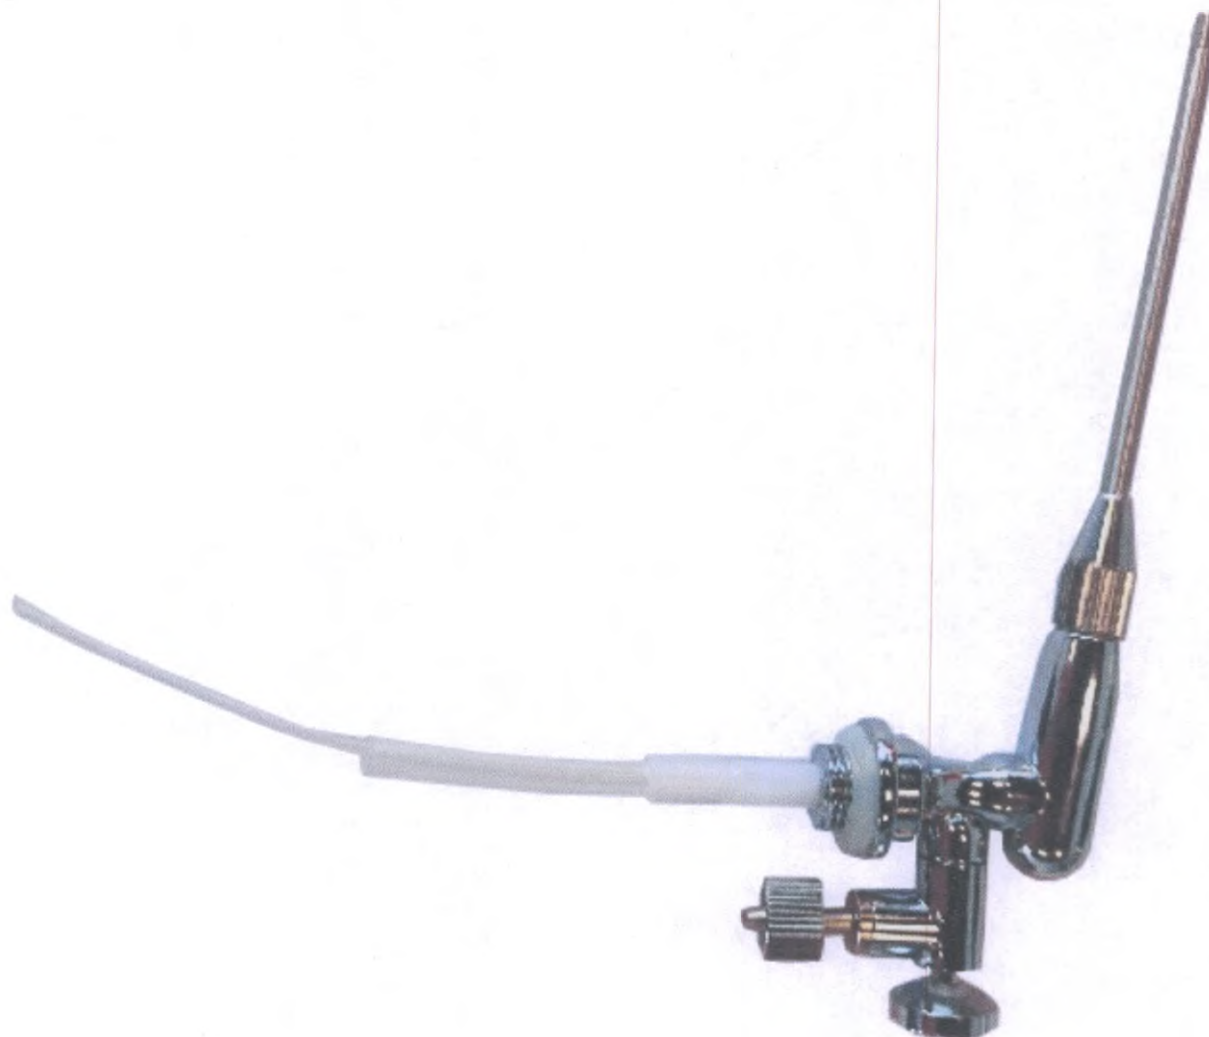


Насадка - распылитель порошковых лекарственных средств (прямая): для пистолета воздушного с пластиковым курком

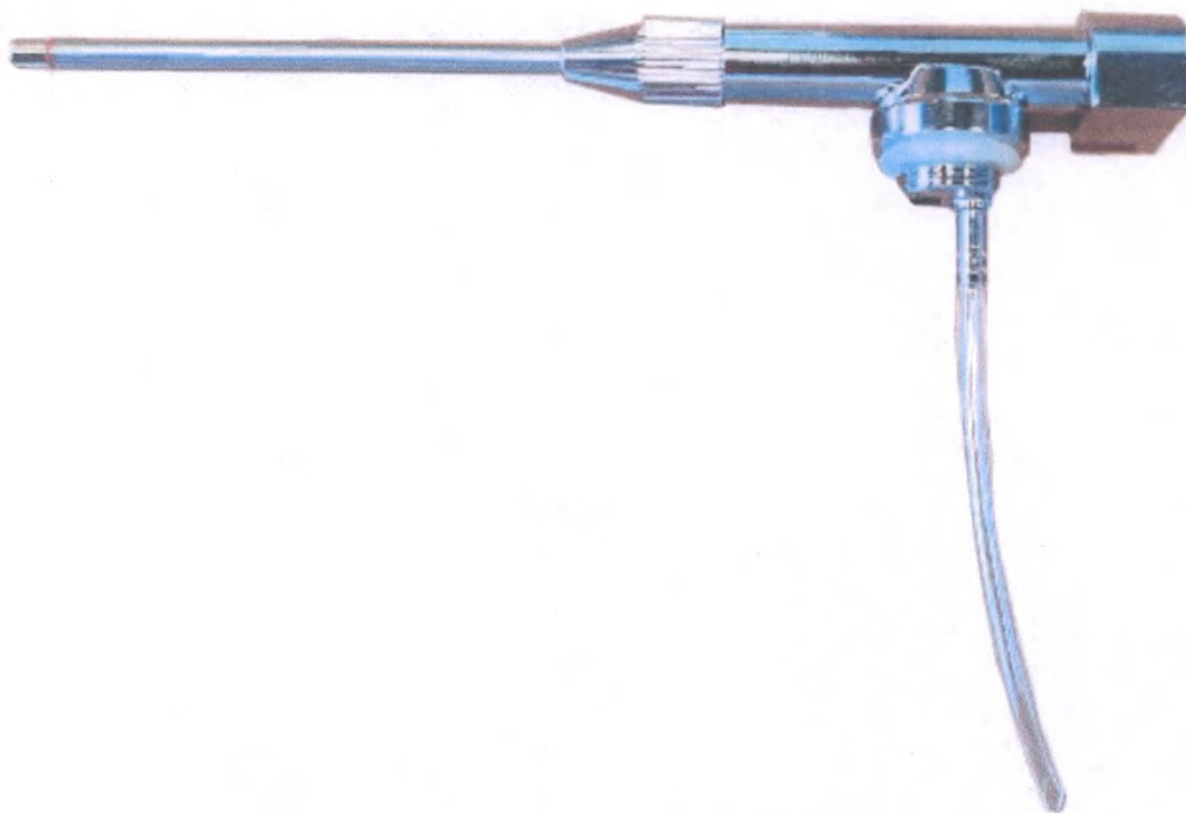

Насадка - распылитель порошковых лекарственных средств (прямая): для пистолета воздушного с металлическим курком

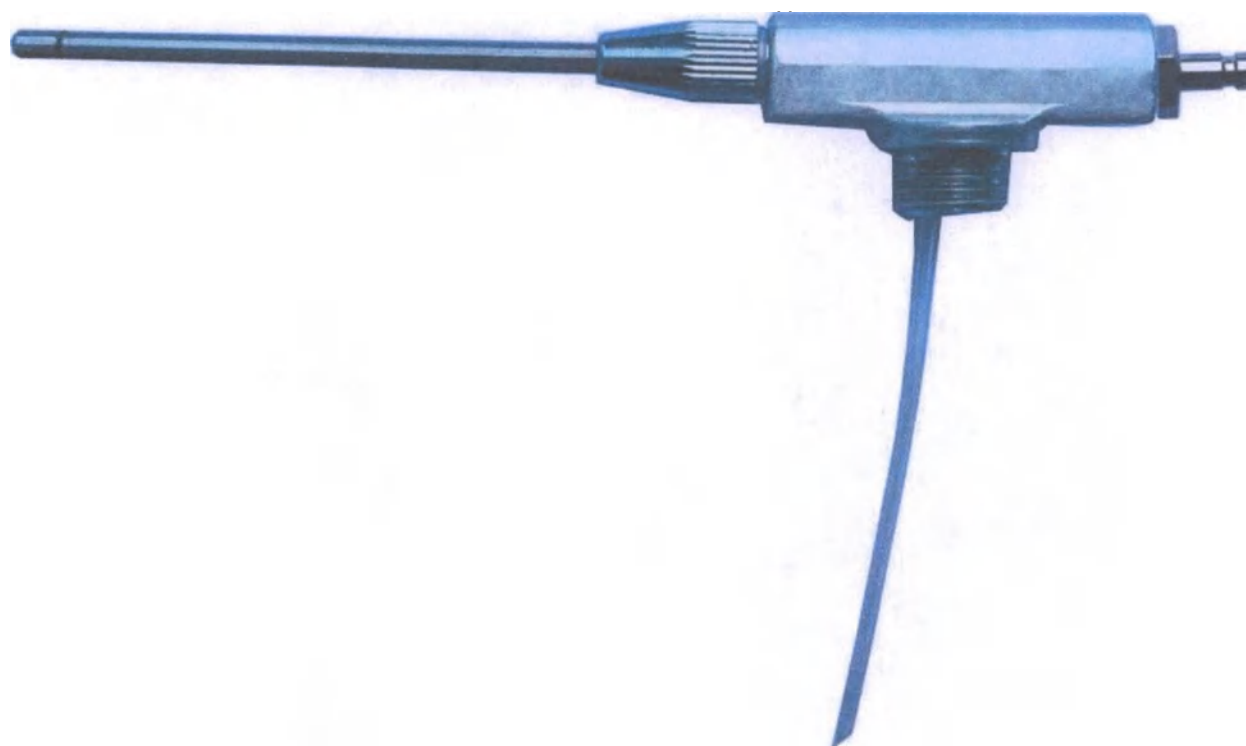


Насадка - распылитель порошковых лекарственных средств (прямая): для пистолета воздушного без курка

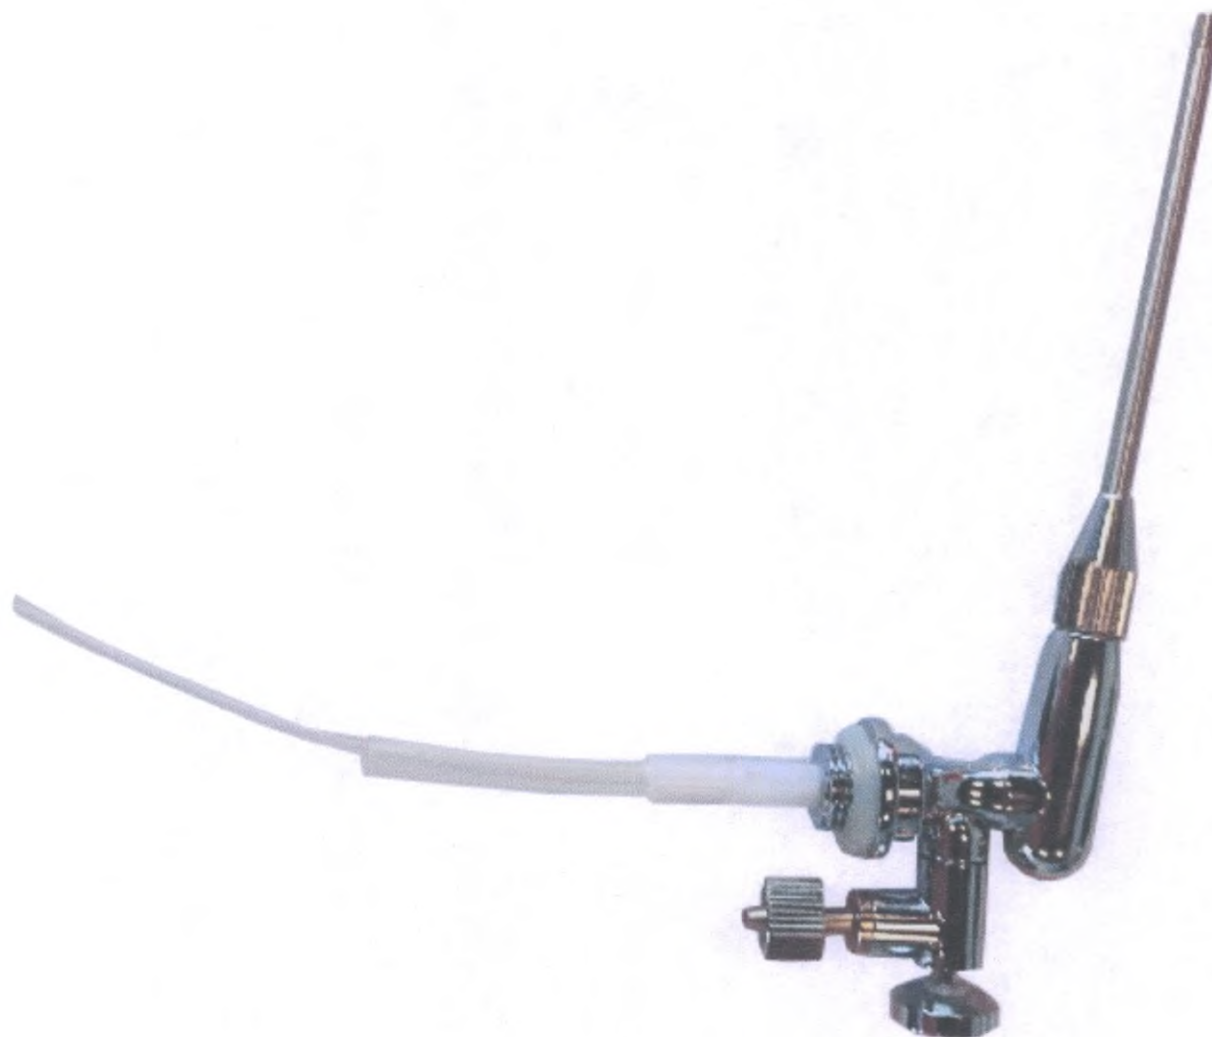

Емкость для лекарственных средств для пистолета воздушного с пластиковым курком объемом 30 мл




Емкость для лекарственных средств для пистолета воздушного с металлическим курком объемом 60 мл

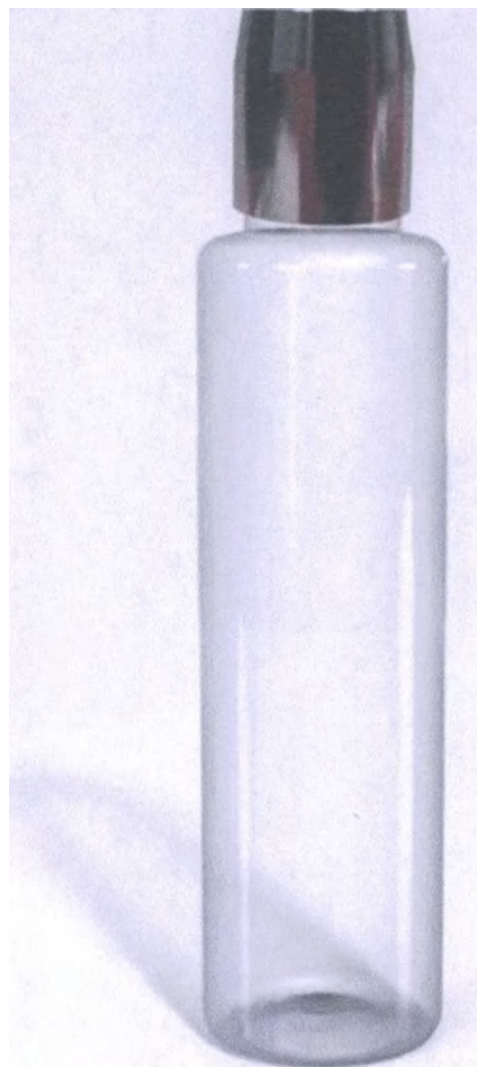

Емкость для лекарственных средств пистолета воздушного без курка объемом 30 мл



Кресло пациента электромеханическое

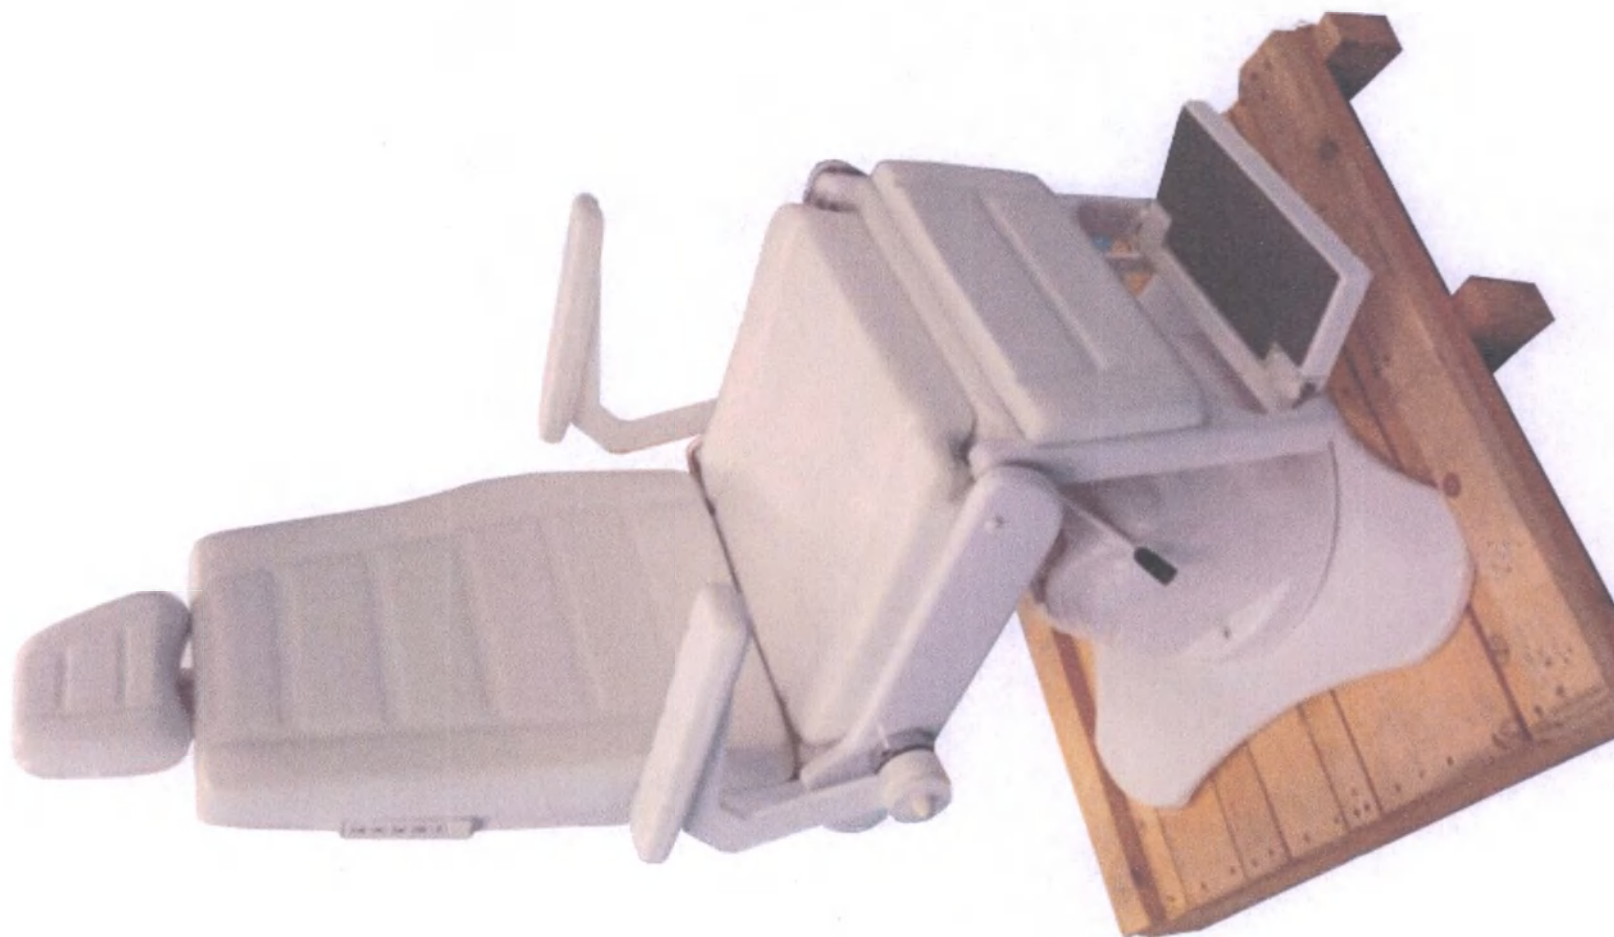


Блок управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD 3in1: блок управления с интегрированным видеодисплеем



Блок управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD 3in1: источник света




Блок управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD 3in1: камера

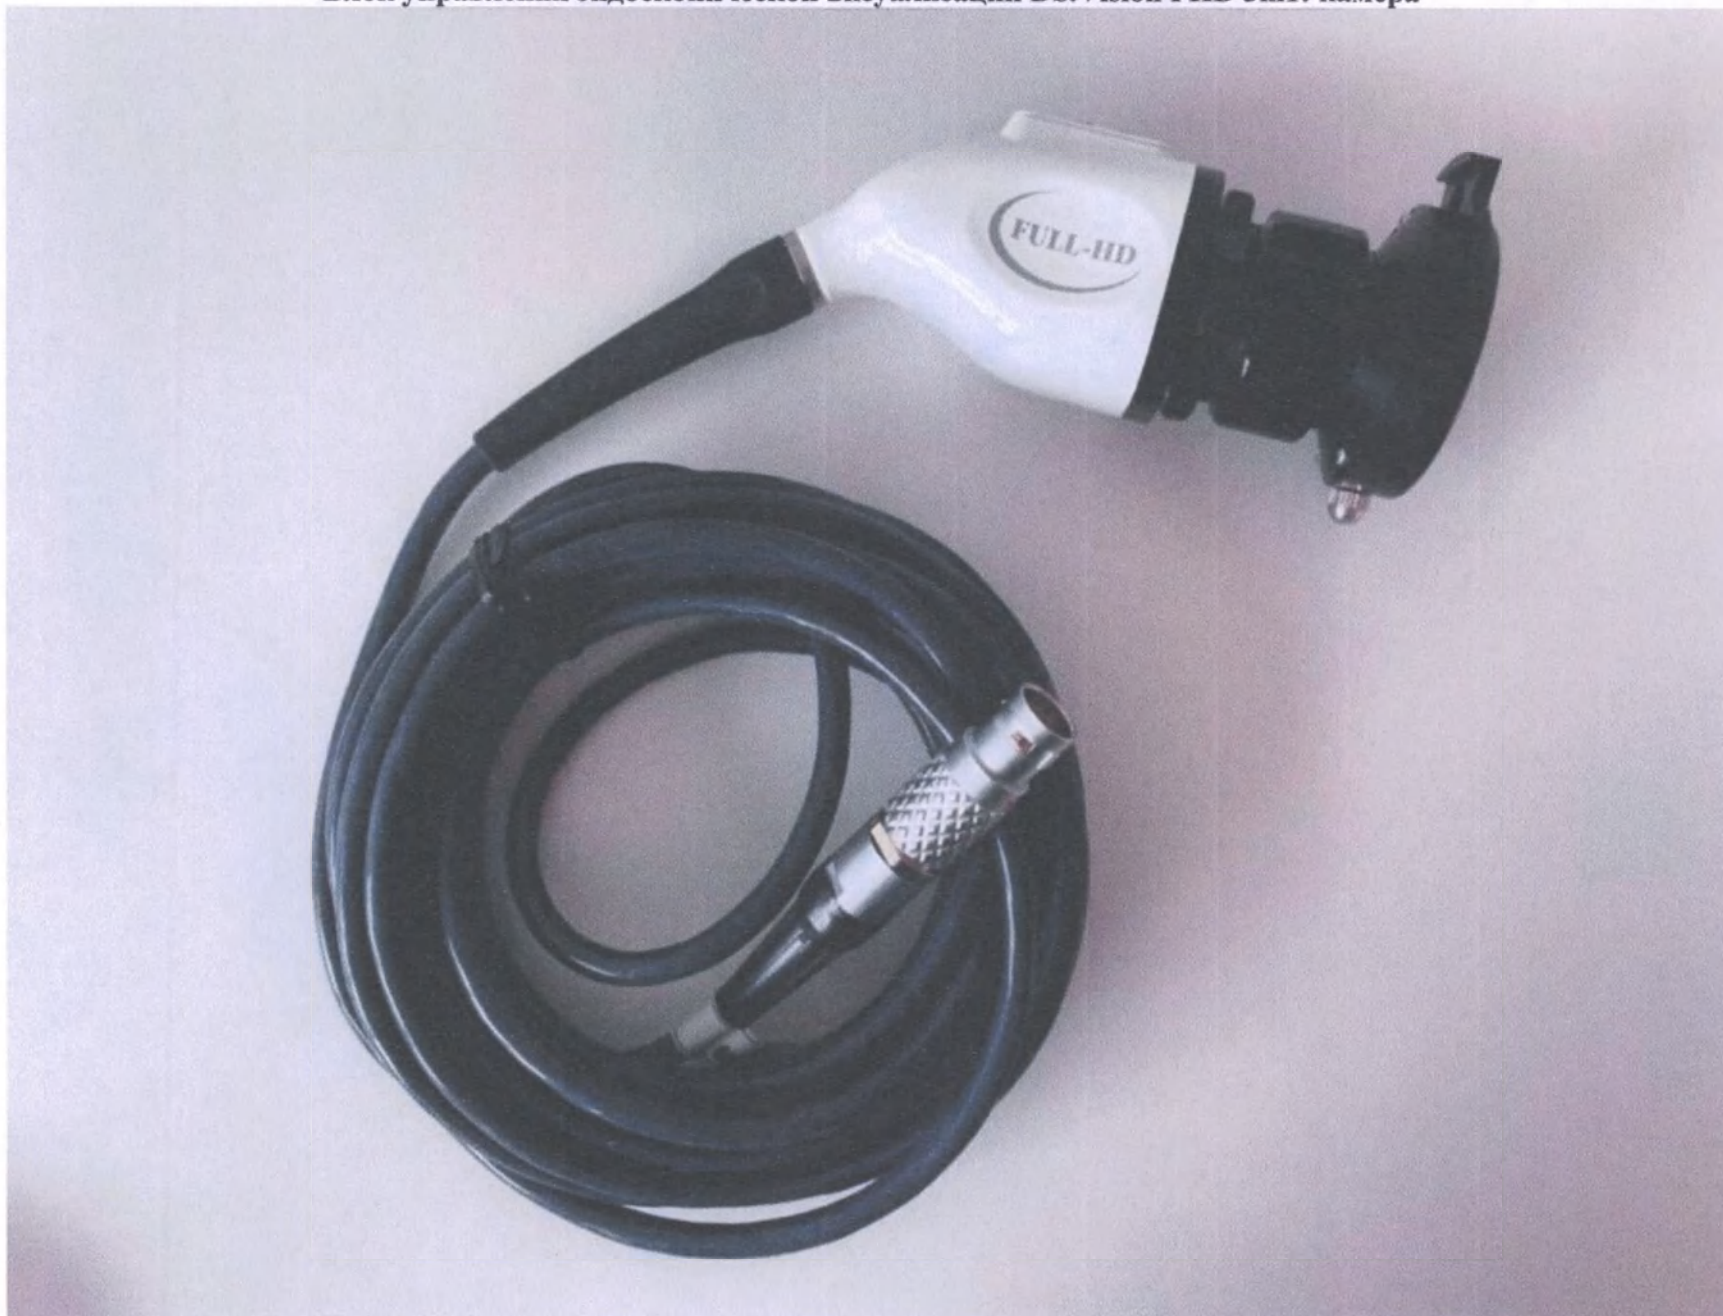

Блок управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD 3in1: адаптер эндоскопа



Блок управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD 3in1: адаптер питания

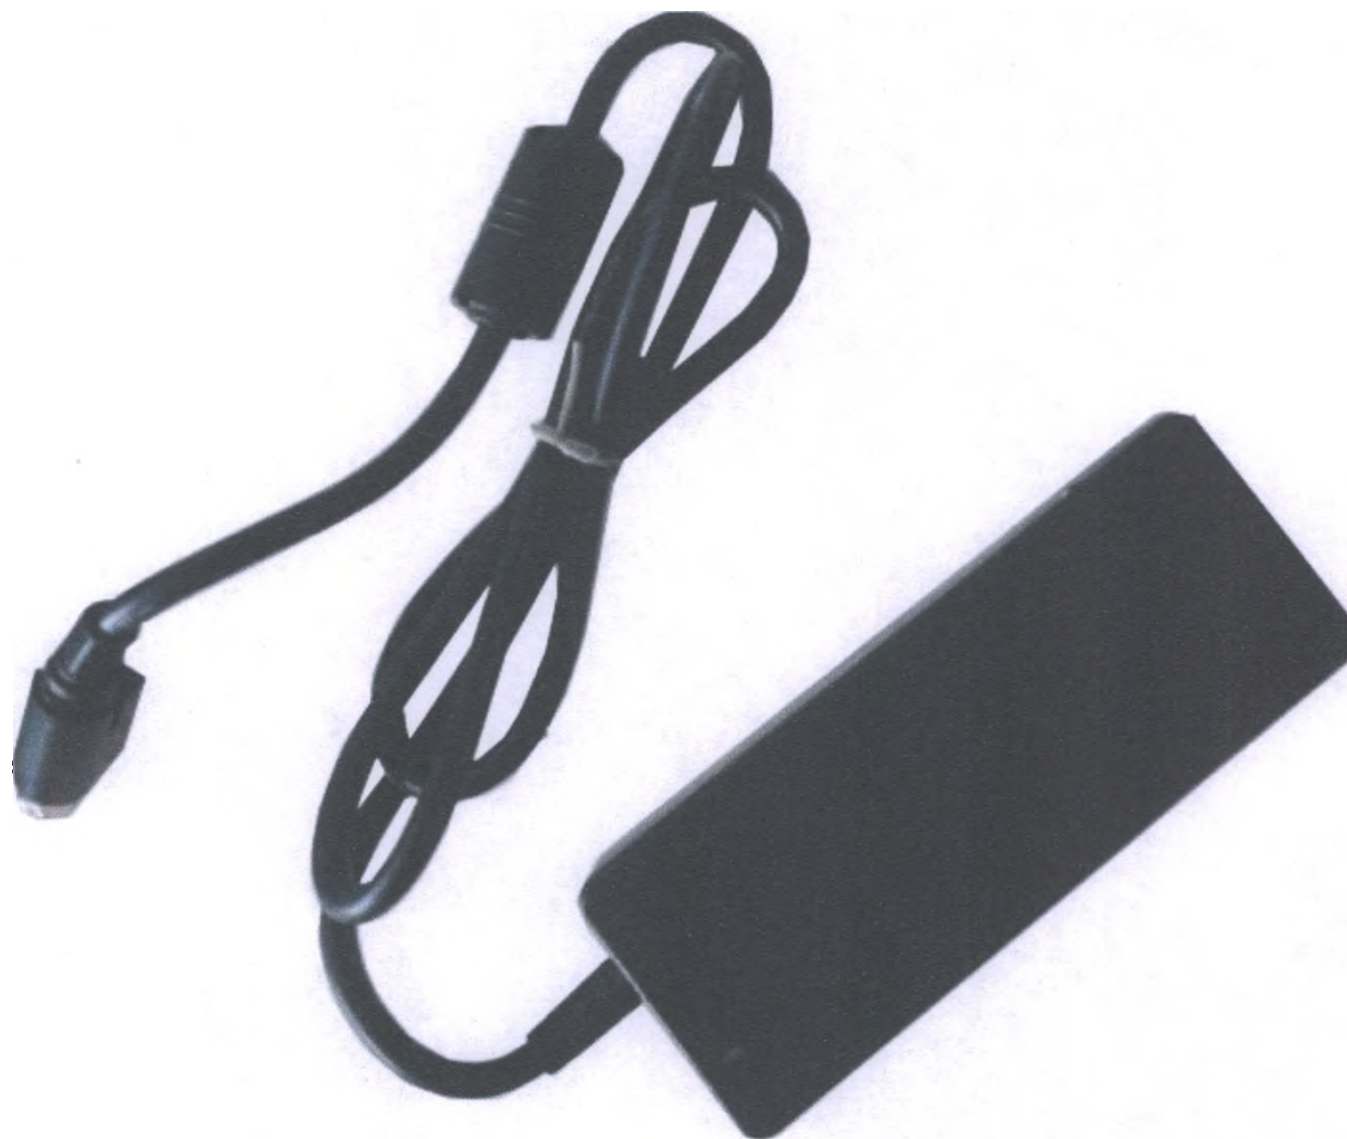

Блок управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD: блок управления



Блок управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD: видеомонитор




Блок управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD: источник света




Блок управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD: камера




Источник света DS.Vision Light с фиброкабелем

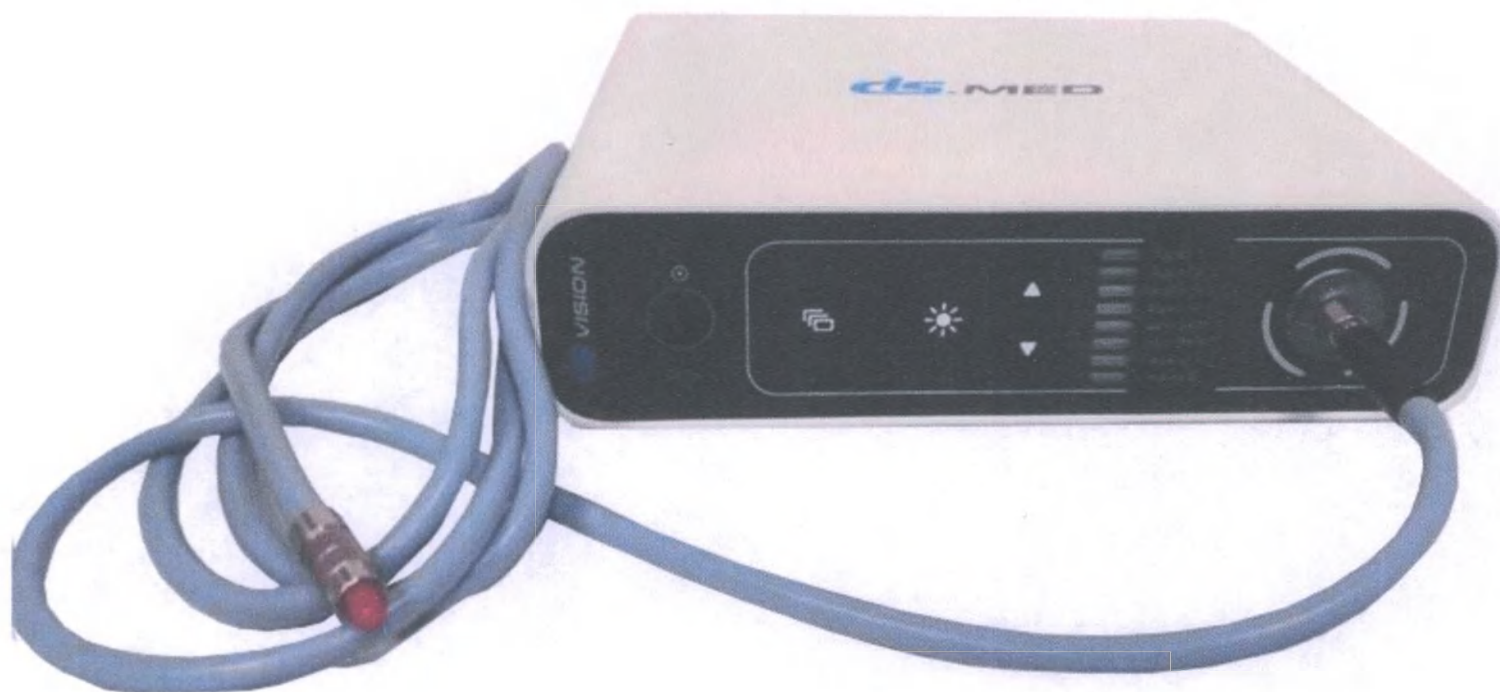


Кабель питания для кресла пациента электромеханического

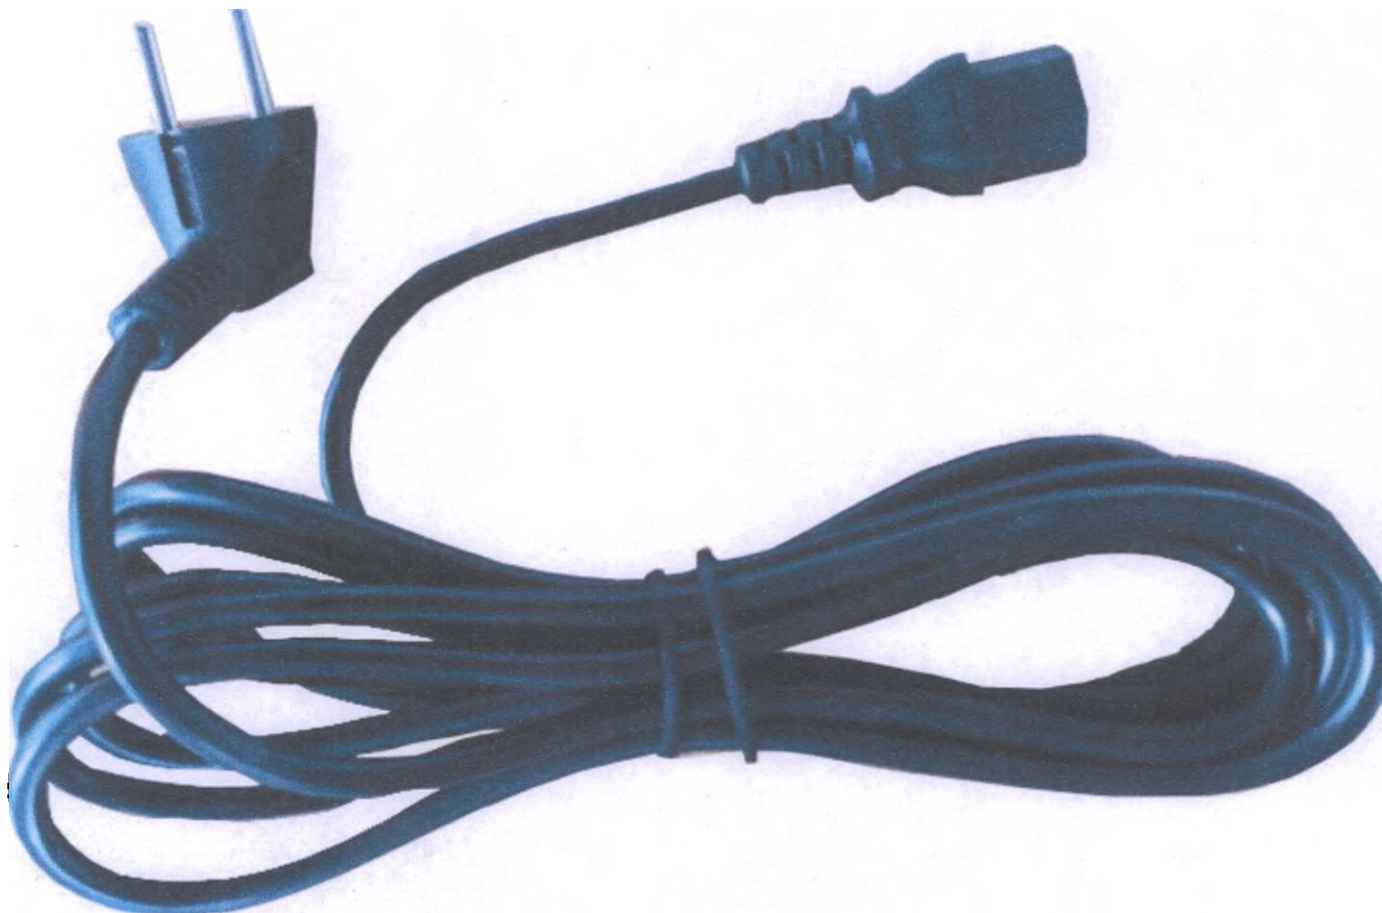


Кабель соединительный для кресла пациента электромеханического

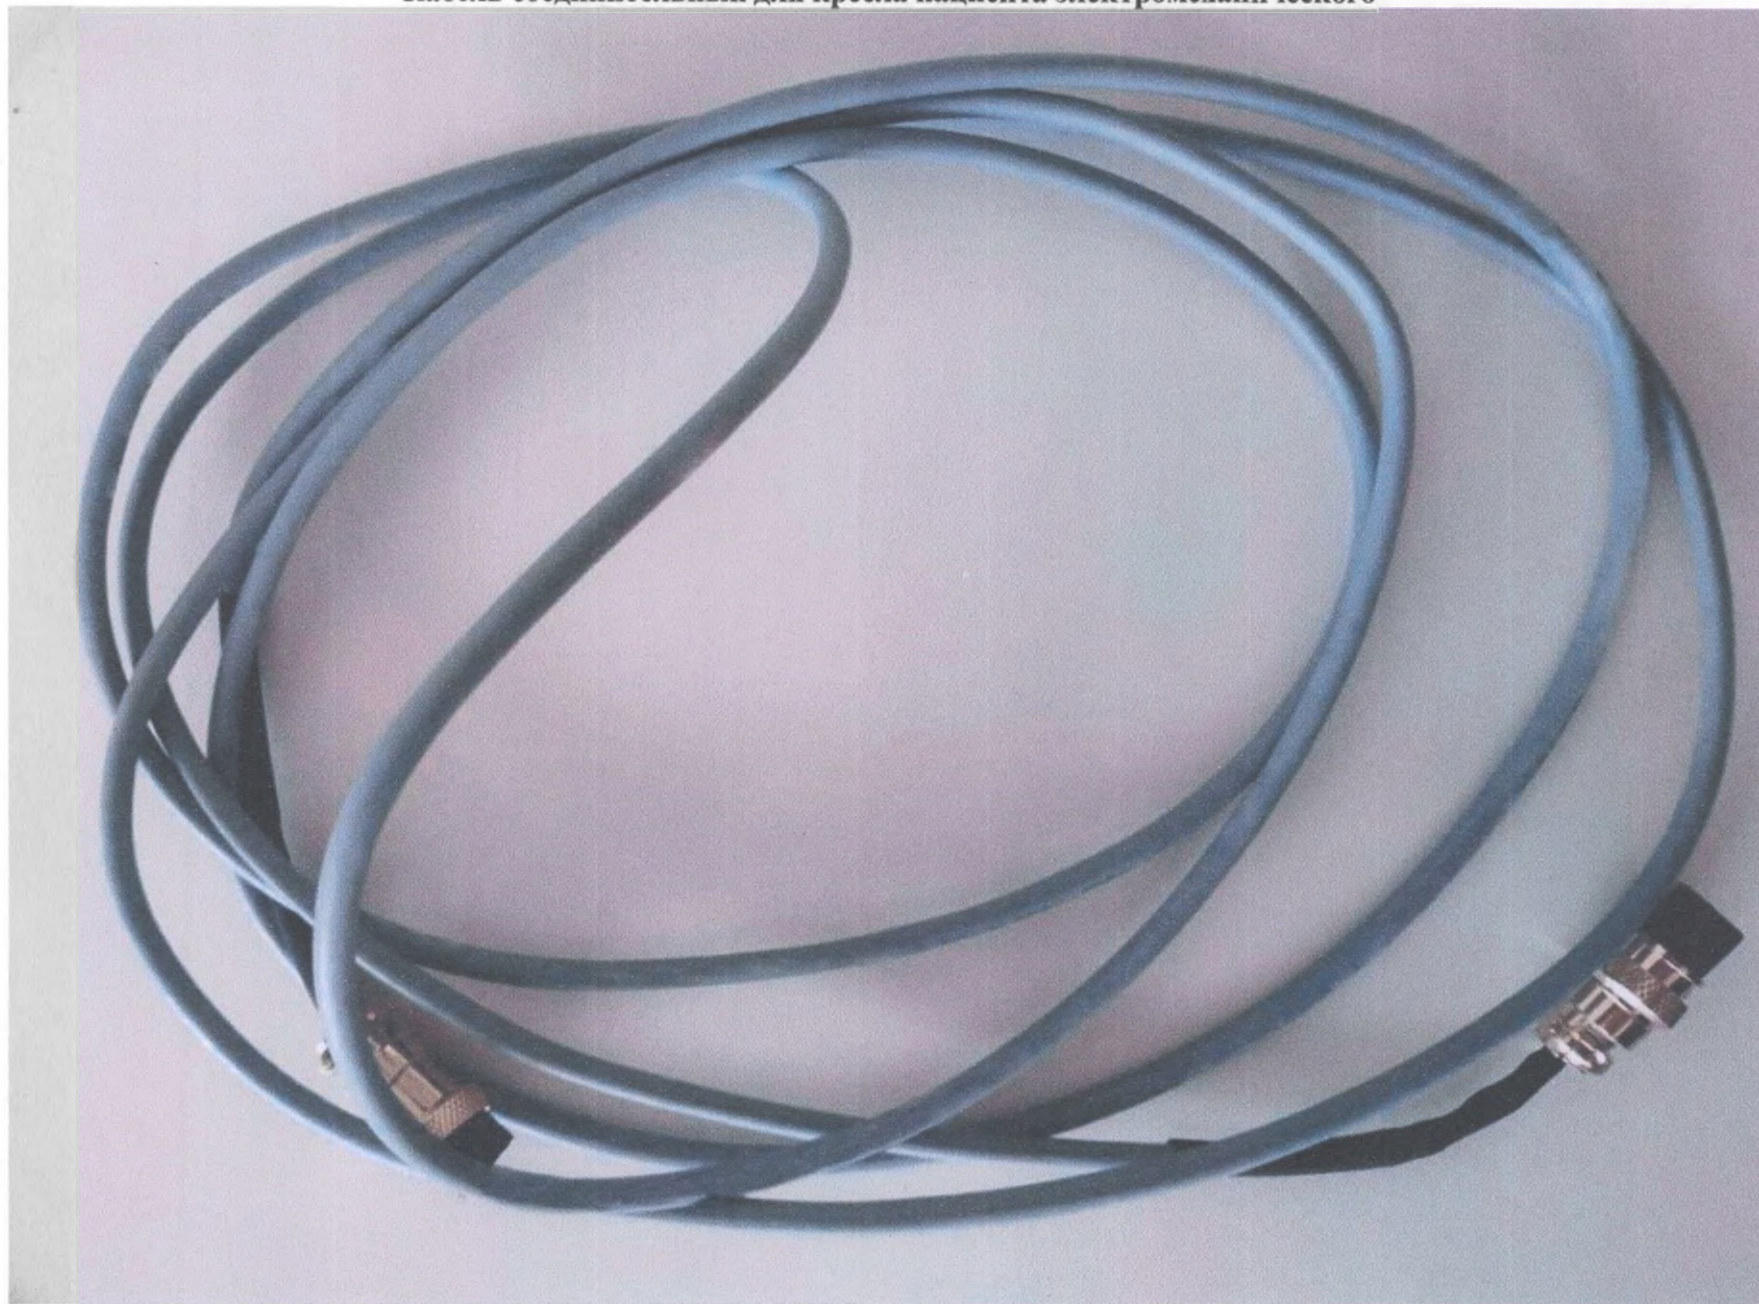


Кабель соединительный для блока управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD 3in1

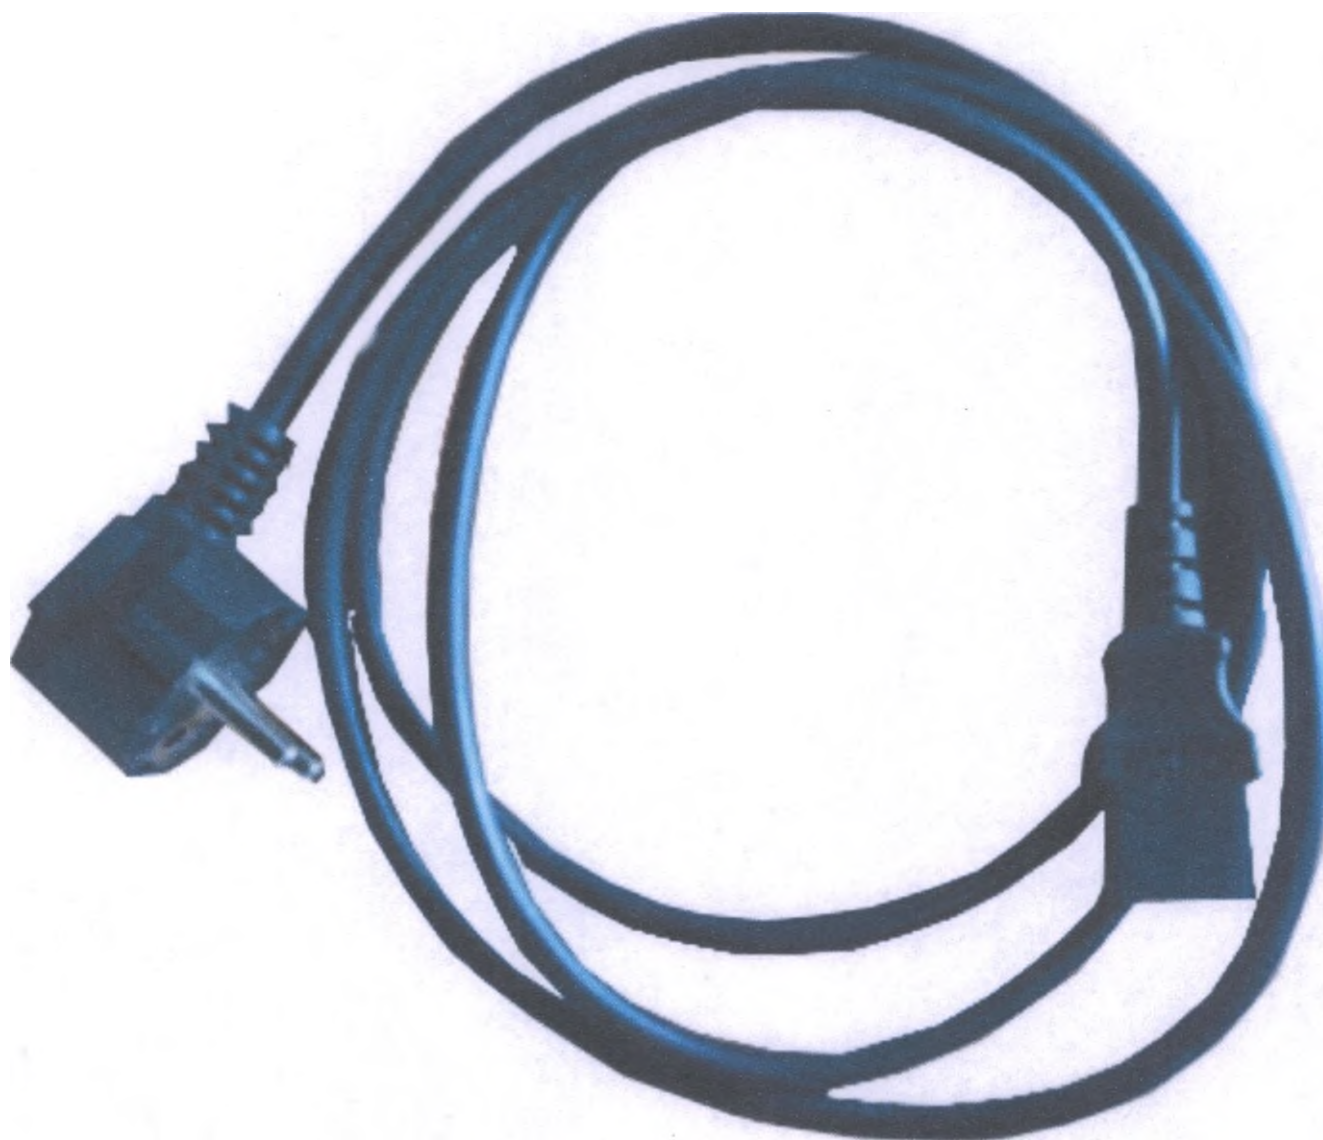


Кабель соединительный для блока управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD

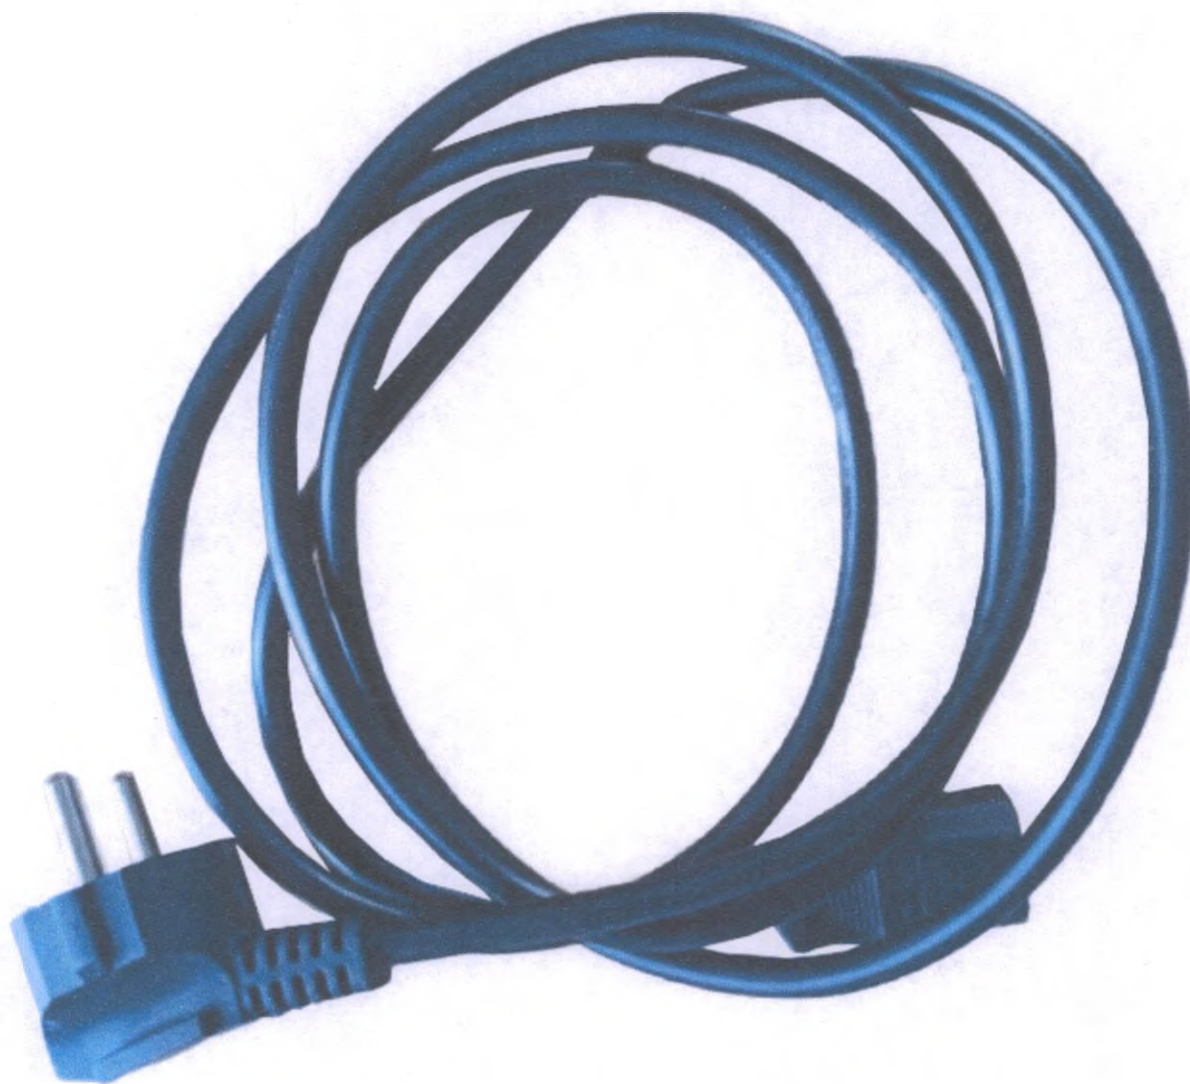

Кабель соединительный для источника света DS.Vision Light с фиброкабелем

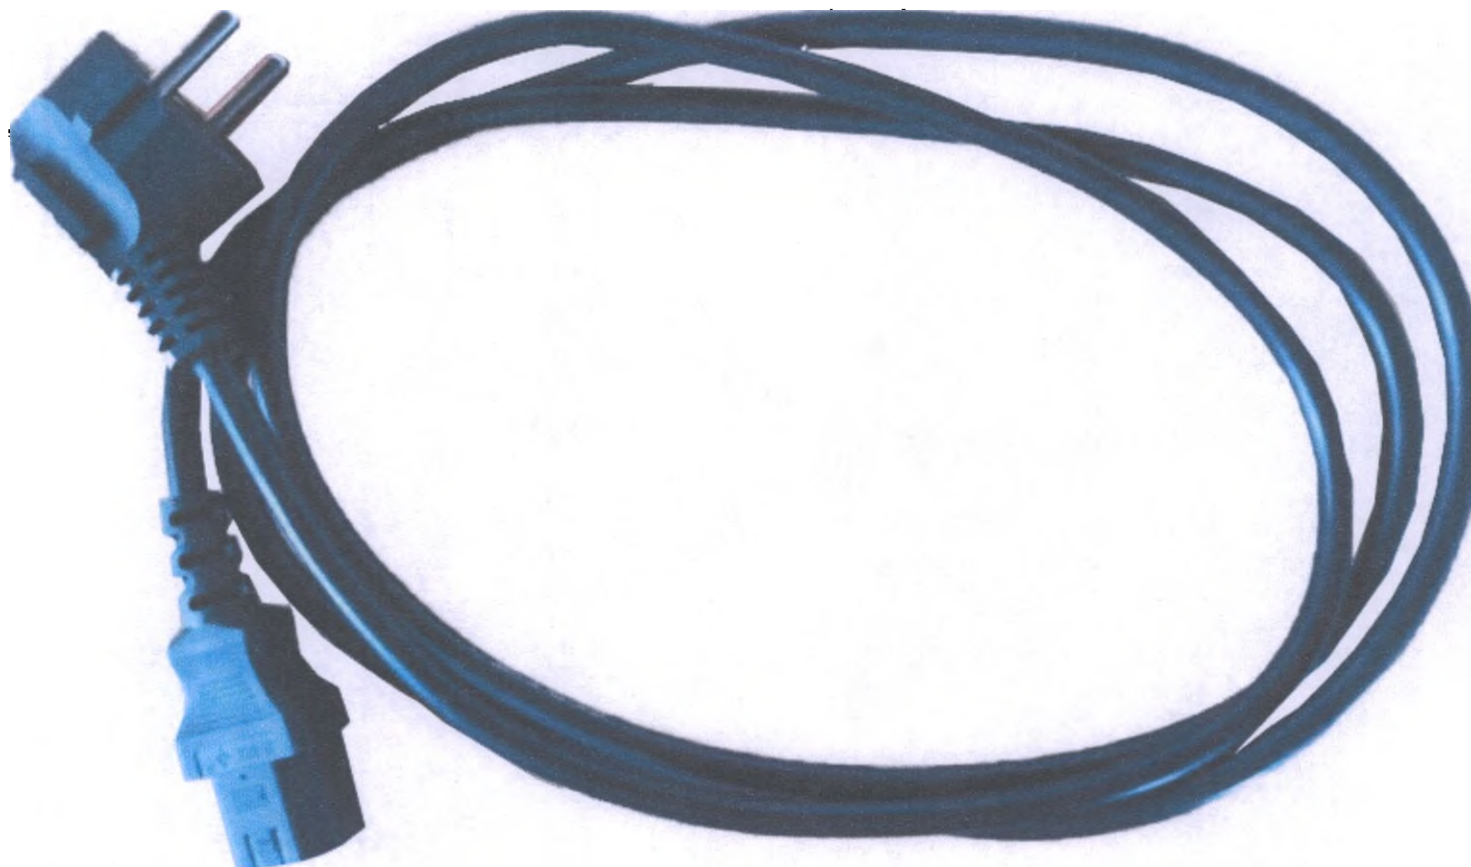

Педальный выключатель

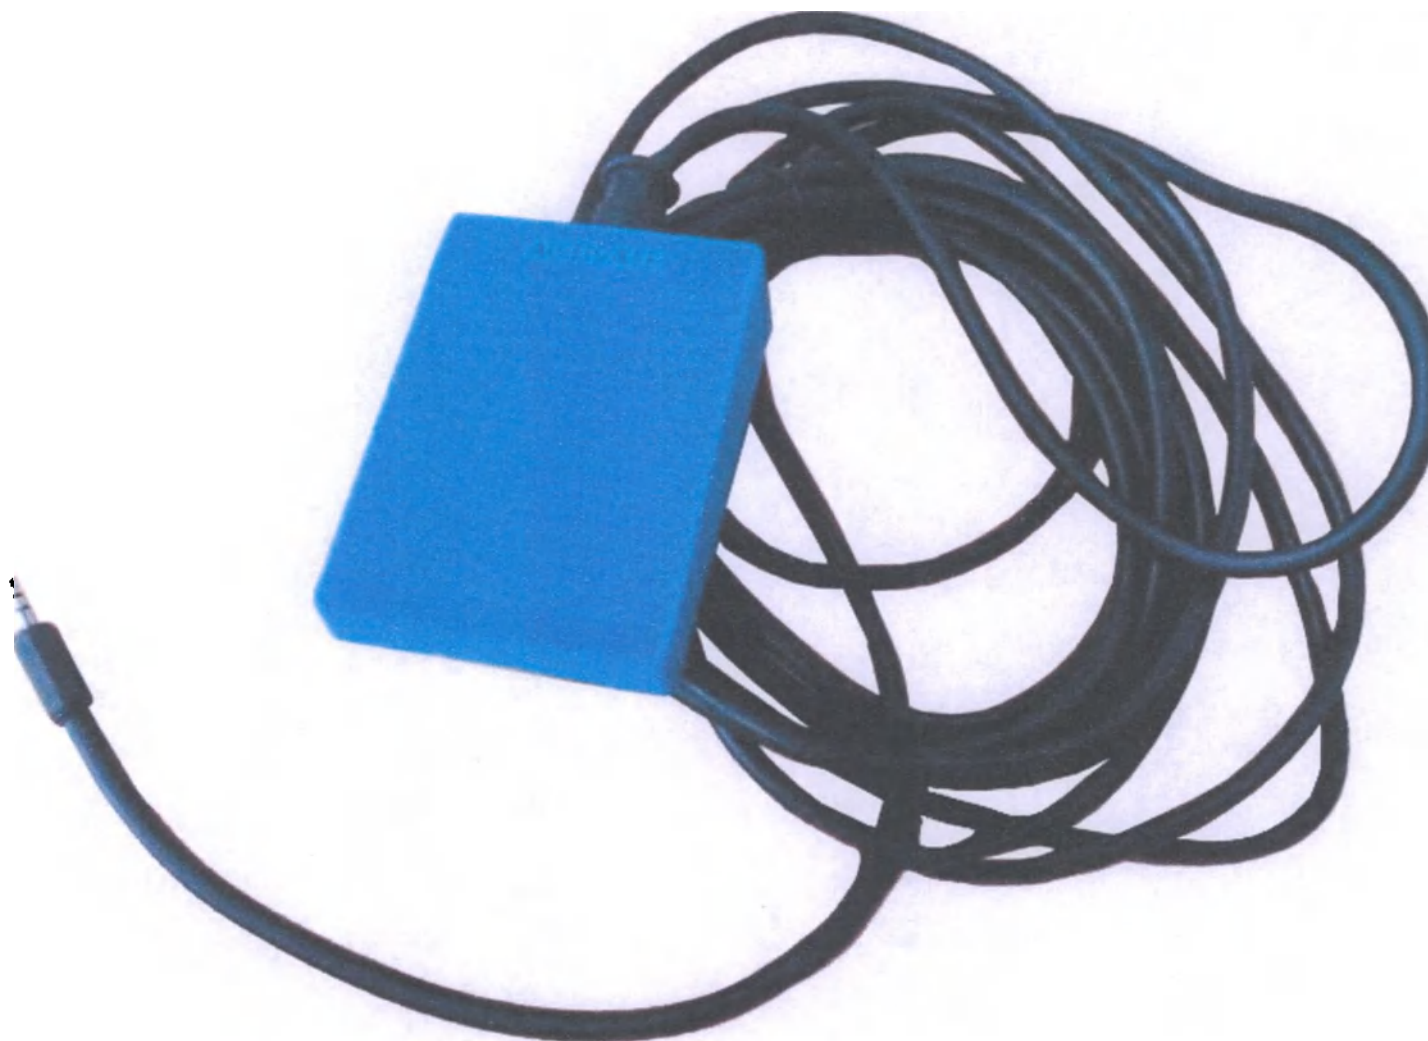

Кабель DVI



Кабель CVBS




Кабель HDMI




Кабель SDI




Стойка приборная DS.T-2-04

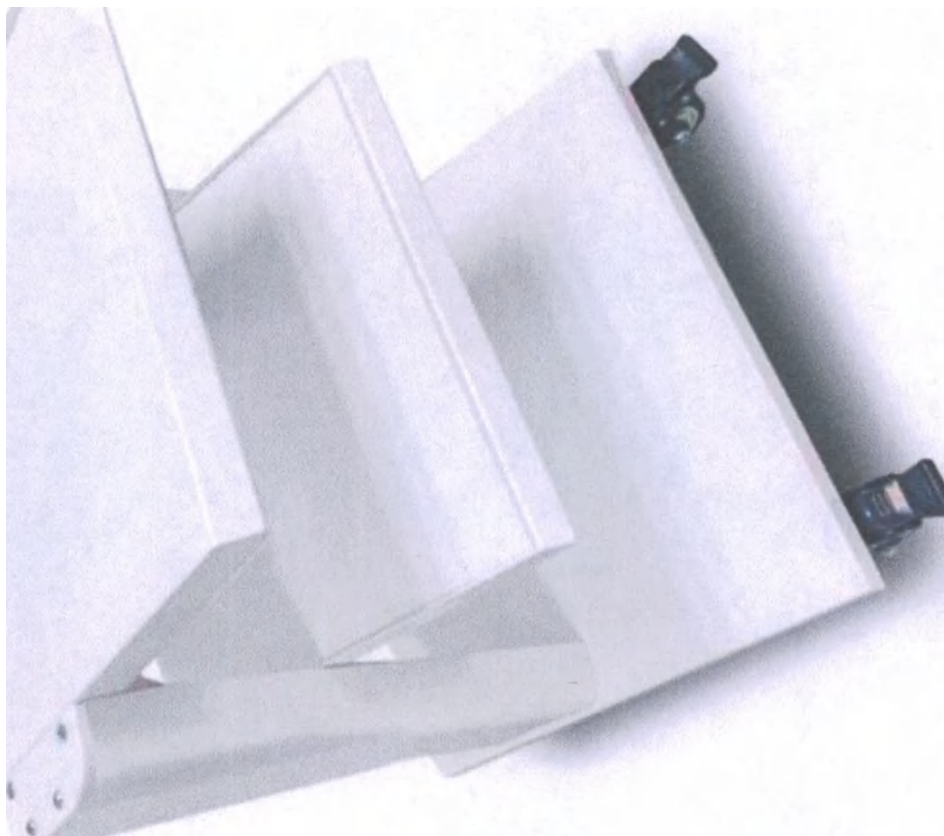

Стойка приборная DS.T-3-07

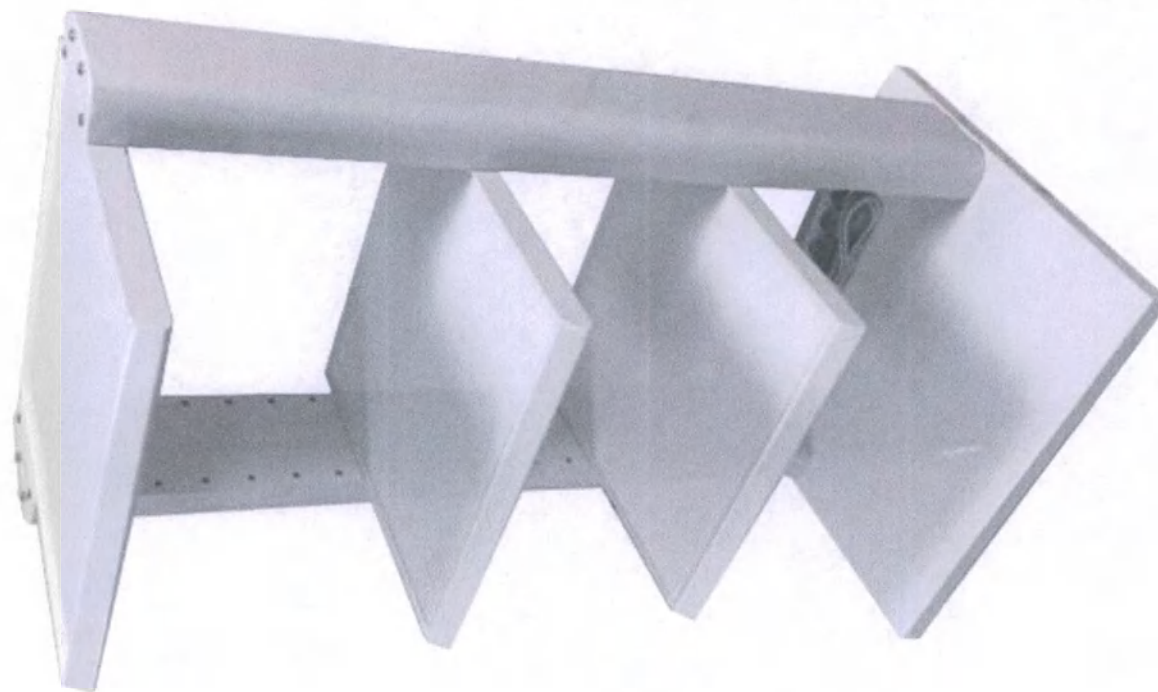


Стойка приборная DS.T-4-03

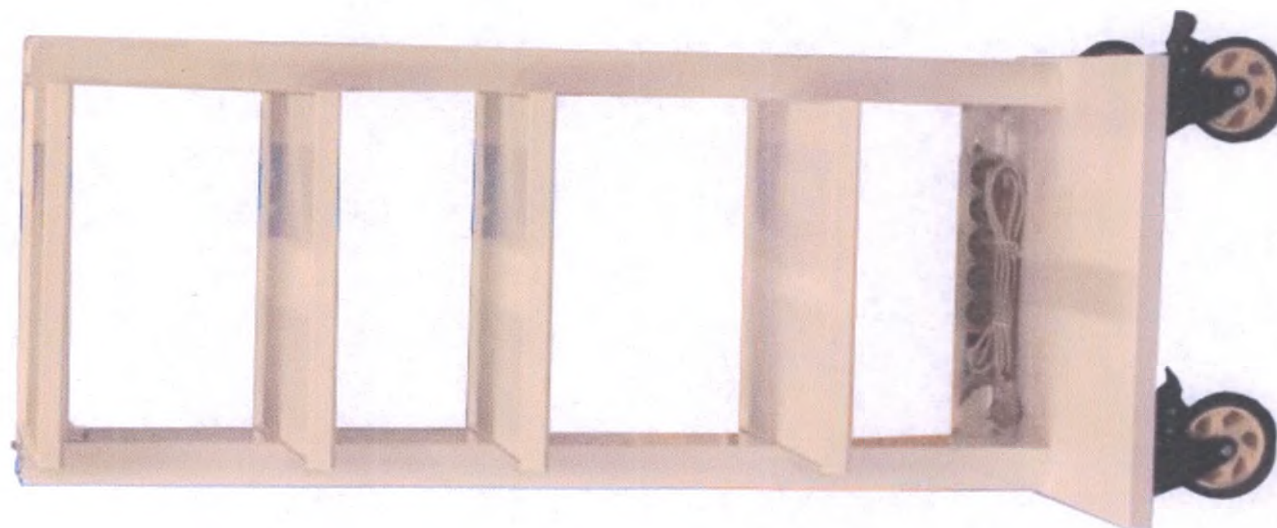


Стойка приборная DS.T-2-05



Стойка приборная DS.T-3-08

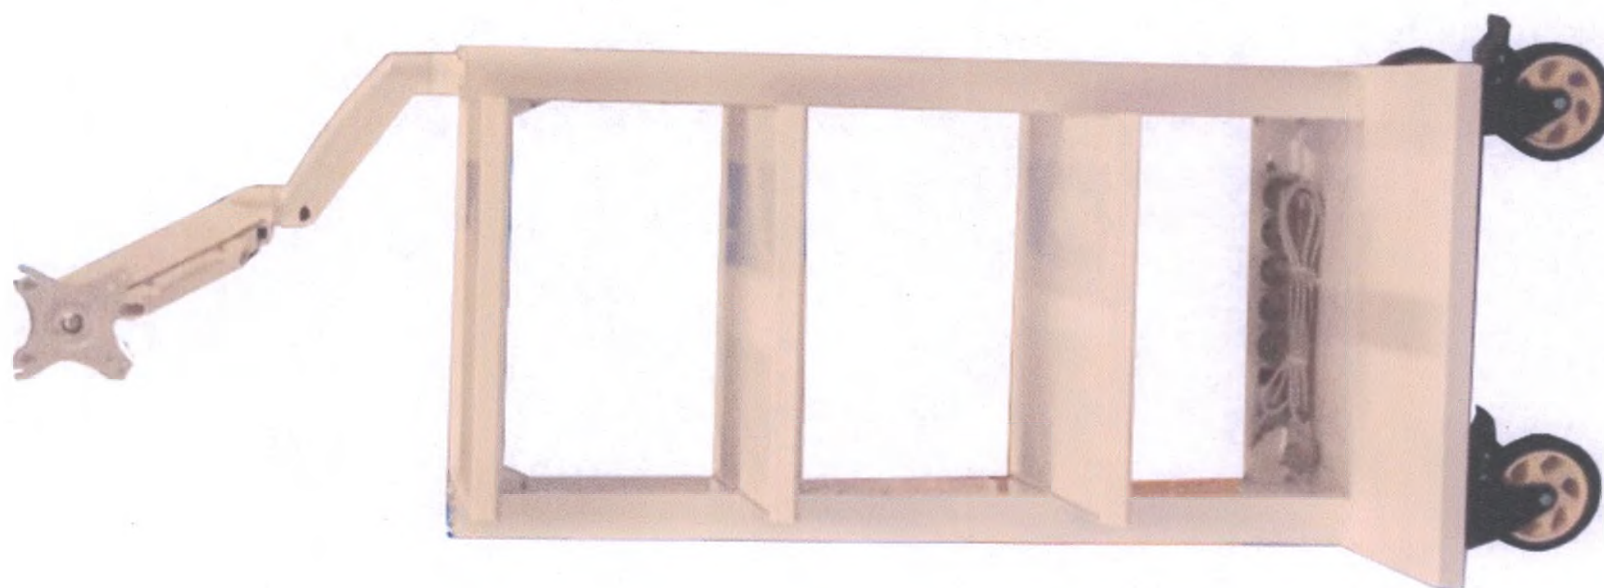


Стойка приборная DS.T-4-04

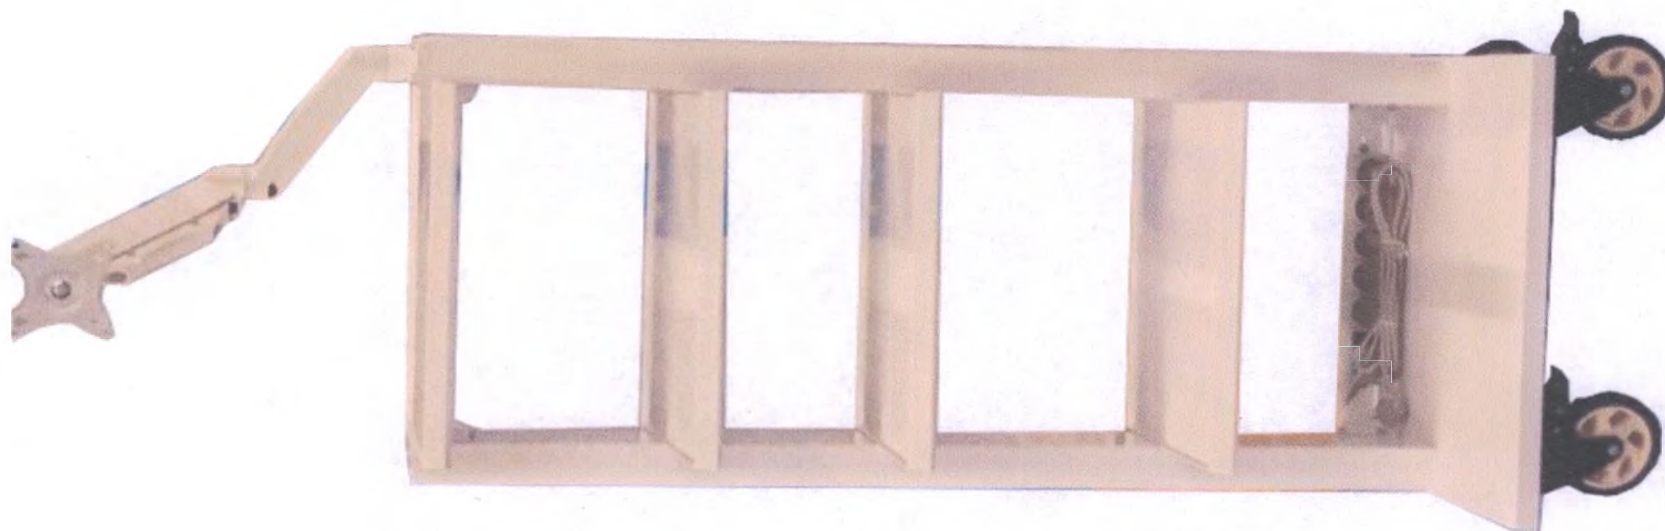


Установка оториноларингологическая DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 вариант исполнения Еигоре, вид спереди




Установка оториноларингологическая DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 вариант исполнения Europe, вид сзади

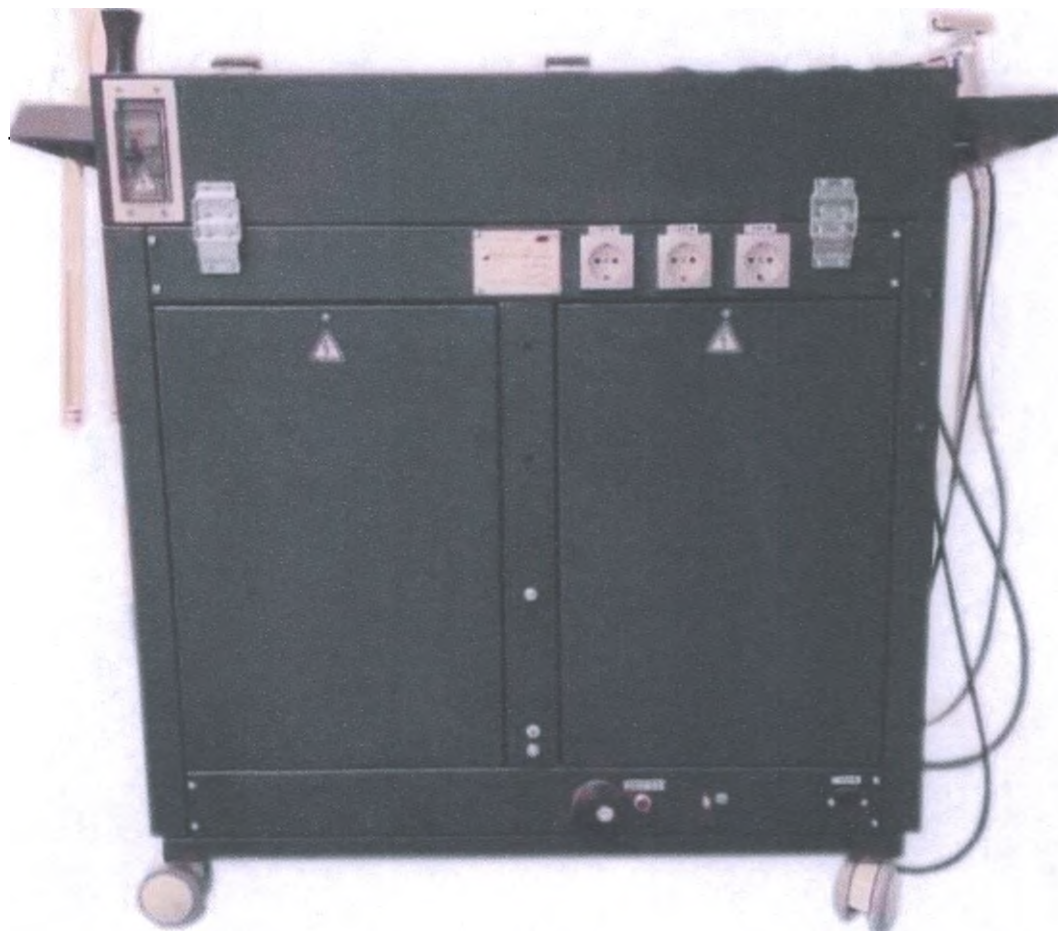

Установка оториноларингологическая DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 вариант исполнения Europe, вид сверху

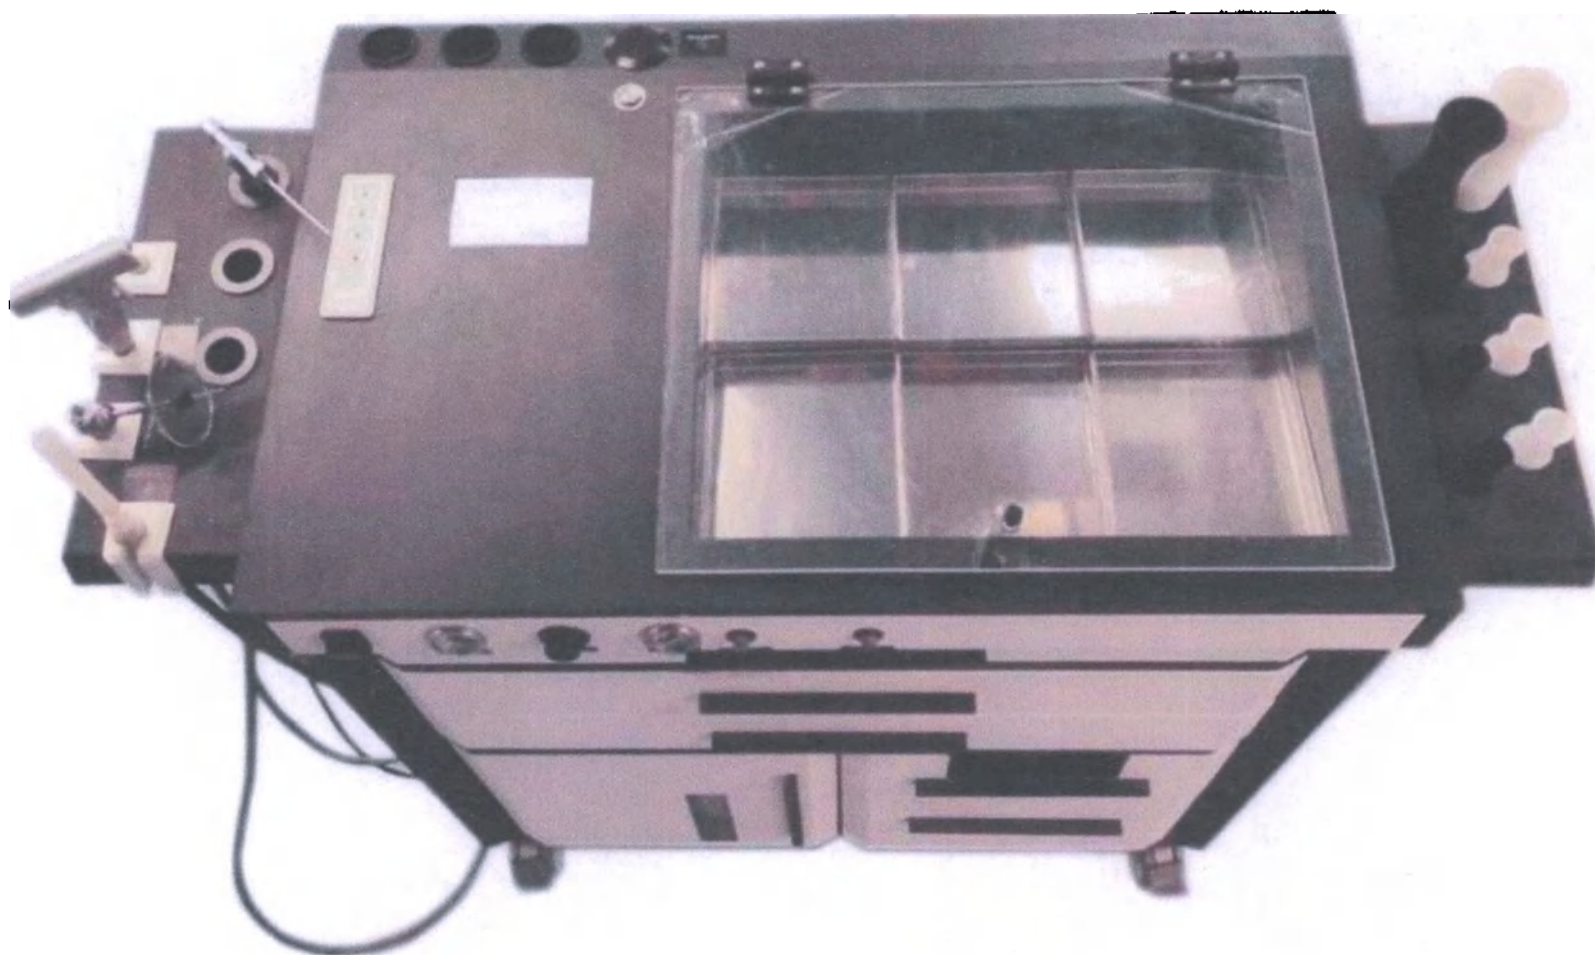

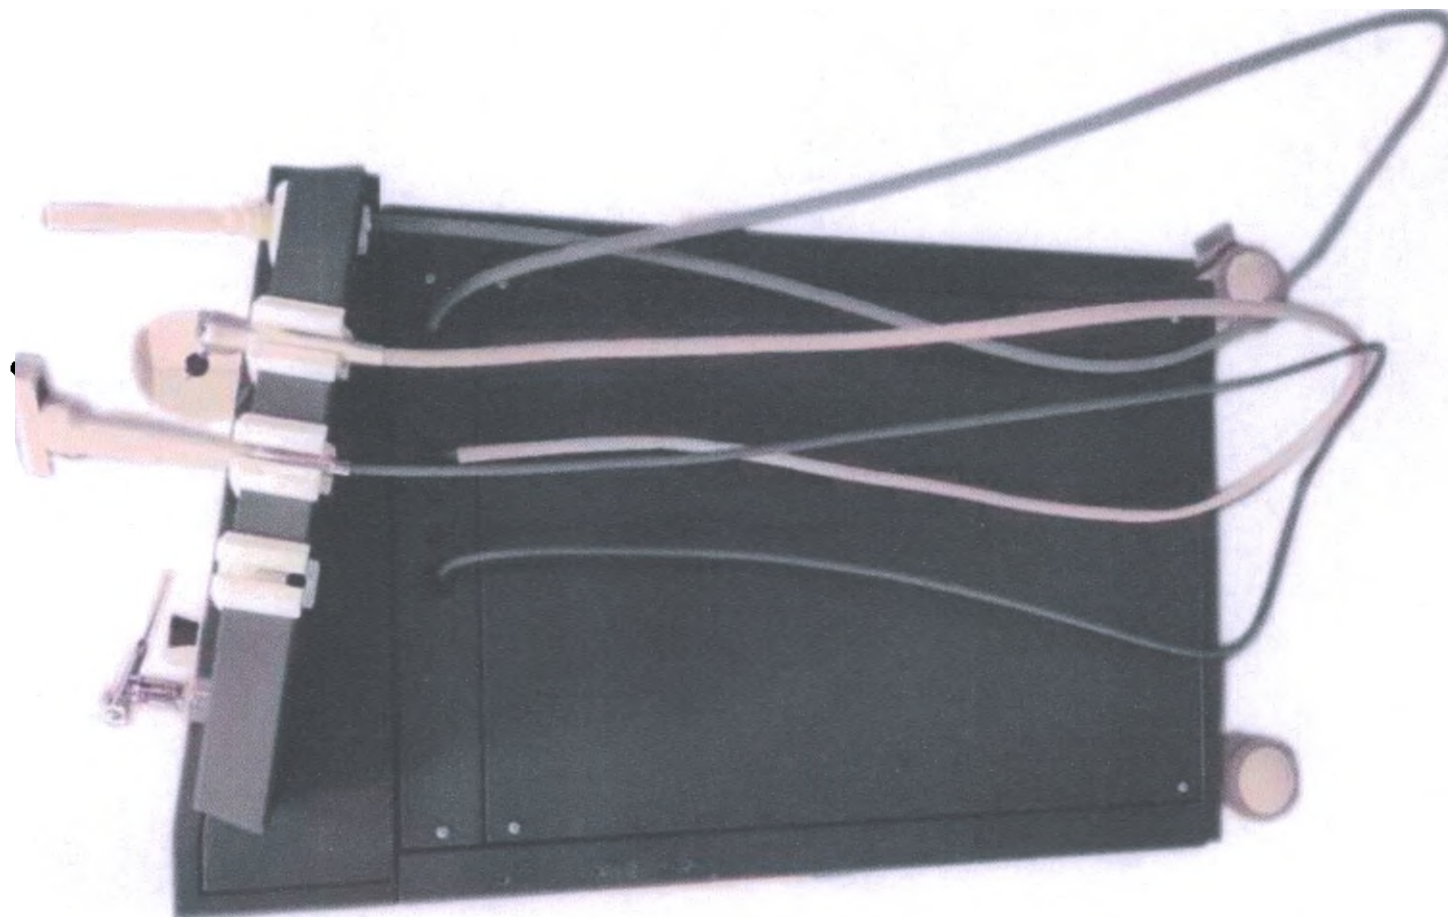

- Шнур сетевого питания
Смотри фото на стр. 6
- Стакан пластиковый для временного хранения чистых жестких эндоскопов
Смотри фото на стр. 7
- Стакан пластиковый для временного хранения использованных жестких эндоскопов
Смотри фото на стр. 8
- Стакан пластиковый для временного хранения чистых гибких эндоскопов
Смотри фото на стр. 9
- Стакан пластиковый для временного хранения использованных гибких эндоскопов
Смотри фото на стр. 10
- Емкость накопительная для секрета
Смотри фото на стр. 11-12
- Адаптер олив
Смотри фото на стр. 13
- Оливы конусообразные из оргстекла разных типоразмеров: диаметр 8 мм, диаметр 11 мм, диаметр 15 мм, диаметр 20 мм
Смотри фото на стр. 14
- Оливы конусообразные металлические разных типоразмеров: диаметр 8мм, диаметр 11 мм, диаметр 15мм, диаметр 20мм
Смотри фото на стр. 15
- Комплект для аспирации и промывания миндалин в составе: рукоятка, колпачок
Смотри фото на стр. 16
- Канюля для аспирации разных типоразмеров: диаметр 1,8 мм, диаметр 3 мм, диаметр 3,5 мм, диаметр 4мм
Смотри фото на стр. 17
- Лоток для сброса использованных инструментов
Смотри фото на стр. 18
- Лоток из нержавеющей стали для инструментов
Смотри фото на стр. 19
- Лоток из нержавеющей стали для принадлежности
Смотри фото на стр. 20
- Держатель пластиковый банок для лекарственных средств
Смотри фото на стр. 21
- Пистолет воздушный для использования с насадками-распылителями лекарственных средств: с пластиковым курком или с металлическим курком или без курка
Смотри фото на стр. 22-24
- Насадка - распылитель жидких лекарственных средств (прямая): для пистолета воздушного с пластиковым курком или для пистолета воздушного с металлическим курком или для пистолета воздушного без курка

Смотри фото на стр. 25-27

Насадка - распылитель жидких лекарственных средств (изогнутая): для пистолета воздушного с пластиковым курком или для пистолета воздушного с металлическим курком или для пистолета воздушного без курка

Смотри фото на стр. 28-30

Насадка - распылитель маслянистых лекарственных средств (прямая): для пистолета воздушного с пластиковым курком или для пистолета воздушного с металлическим курком или для пистолета воздушного без курка

Смотри фото на стр. 31-33

Насадка - распылитель порошковых лекарственных средств (прямая): для пистолета воздушного с пластиковым курком или для пистолета воздушного с металлическим курком или для пистолета воздушного без курка

Смотри фото на стр. 34-36

Емкость для лекарственных средств для пистолета воздушного с пластиковым курком объемом 30 мл или для пистолета воздушного с металлическим курком объемом 60 мл или для пистолета воздушного без курка объемом 30 мл

Смотри фото на стр. 37-39

Кресло пациента электромеханическое

Смотри фото на стр. 40


Тюльпан для промывания уха




Насадка-сопло для впрыскивания воды под давлением



Защита от брызг

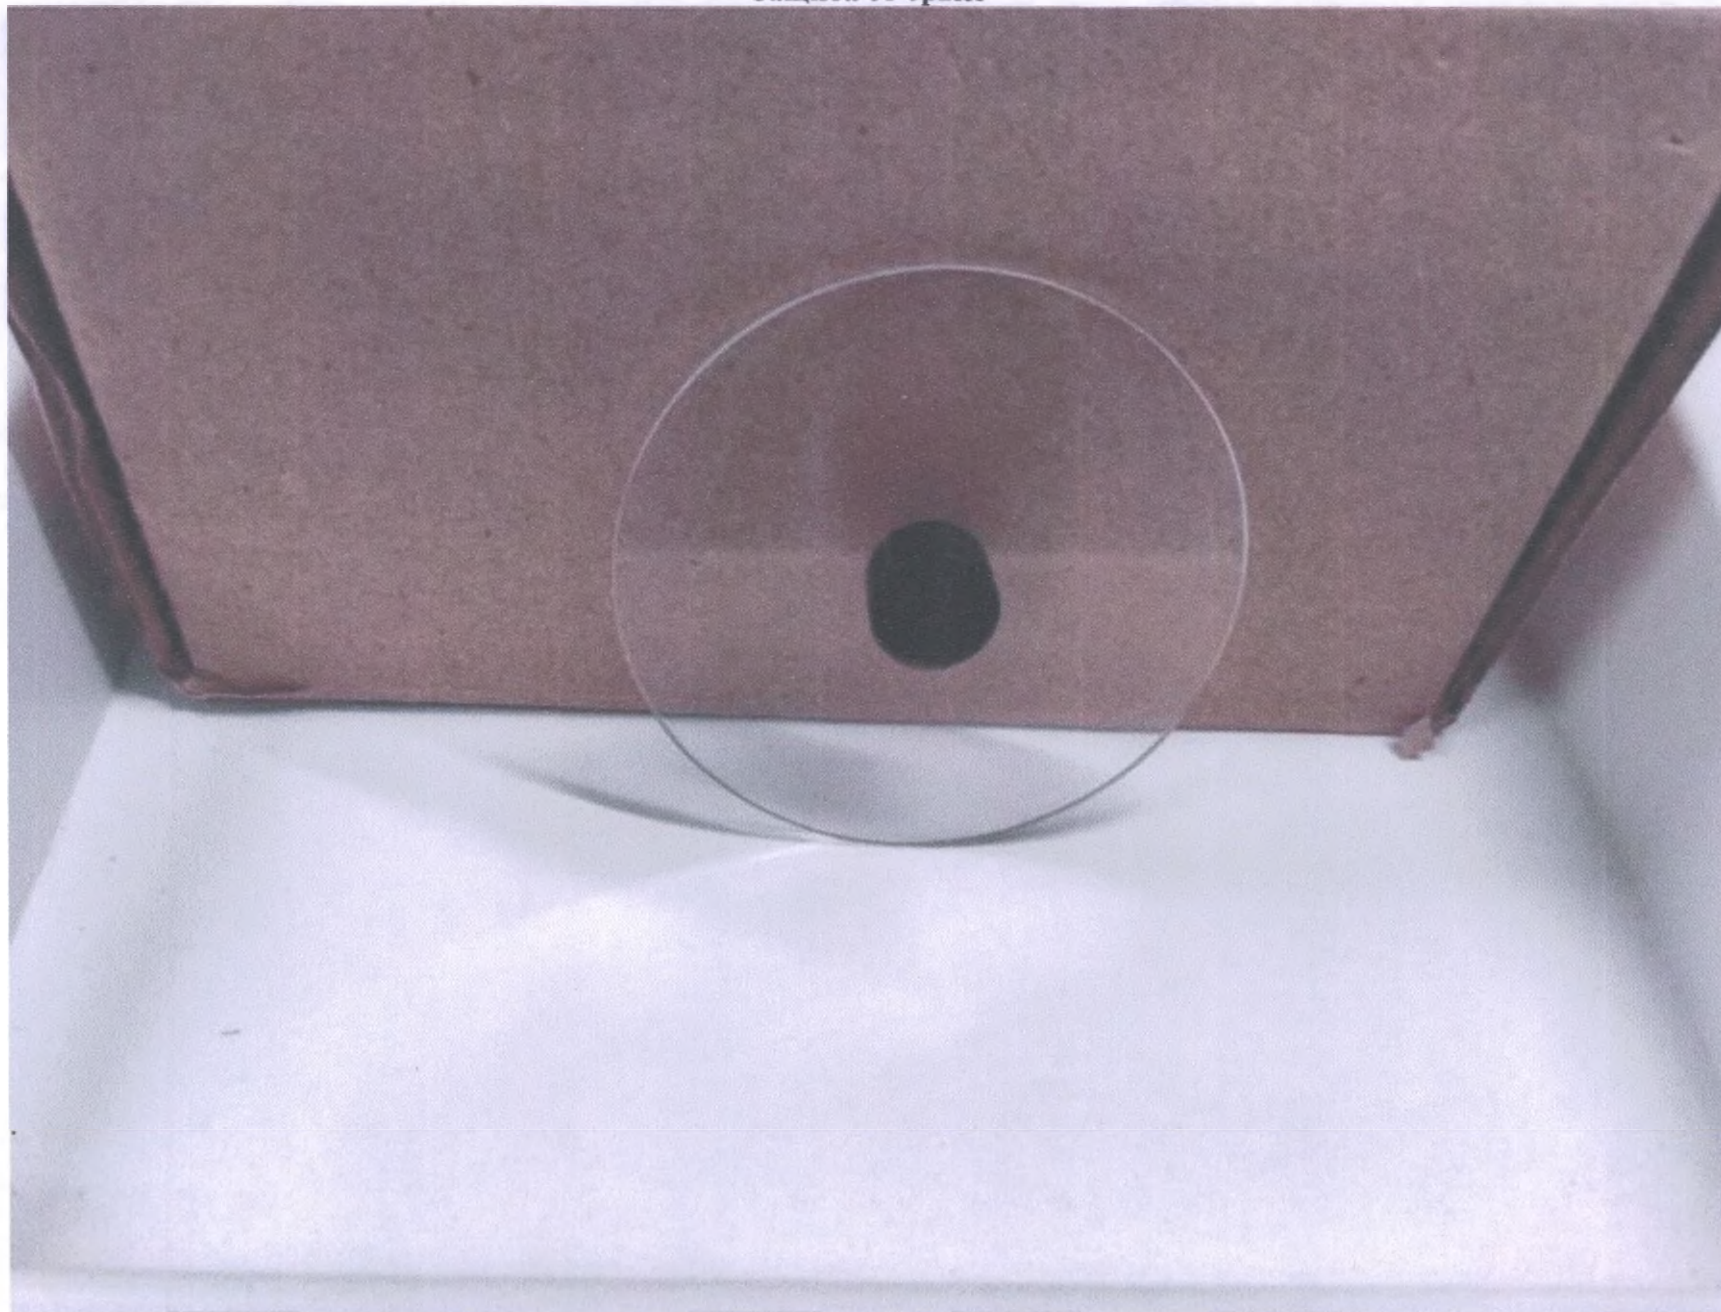

Резервуар для системы промывания полостей объемом 2 л

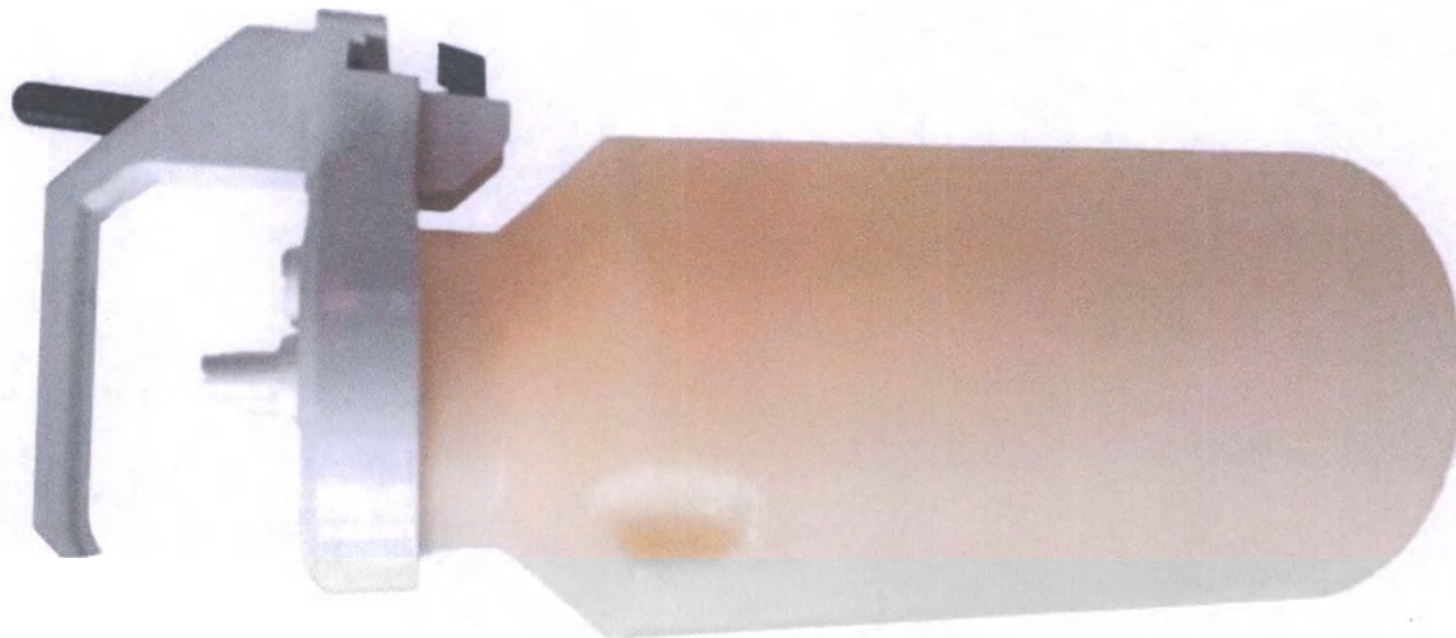

Блок управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD 3in1 с интегрированным видеодисплеем, источником света, камерой, адаптером эндоскопа, адаптером питания

Смотри фото на стр. 41-45

Блок управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD с видеомонитором, источником света, камерой

Смотри фото на стр. 46-49

Источник света DS.Vision Light с фиброкабелем

Смотри фото на стр. 50

Кабель питания для кресла пациента электромеханического

Смотри фото на стр. 51

Кабель соединительный для кресла пациента электромеханического

Смотри фото на стр. 52

Кабель соединительный для блока управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD 3in1

Смотри фото на стр. 53

Кабель соединительный для блока управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD

Смотри фото на стр. 54

Кабель соединительный для источника света DS.Vision Light с фиброкабелем

Смотри фото на стр. 55

Педальный выключатель

Смотри фото на стр. 56

Кабель DVI

Смотри фото на стр. 57

Кабель CVBS

Смотри фото на стр. 58

Кабель HDMI

Смотри фото на стр. 59

Кабель SDI

Смотри фото на стр. 60

Стойка приборная DS.T-2-04

Смотри фото на стр. 61

Стойка приборная DS.T-3-07

Смотри фото на стр. 62

Стойка приборная DS.T-4-03

Смотри фото на стр. 63


Стойка приборная DS.T-2-05


Смотри фото на стр. 64

Стойка приборная DS.T-3-08
Смотри фото на стр. 65
Стойка приборная DS.T-4-04
Смотри фото на стр. 66

Установка оториноларингологическая DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 вариант исполнения Compact, вид спереди



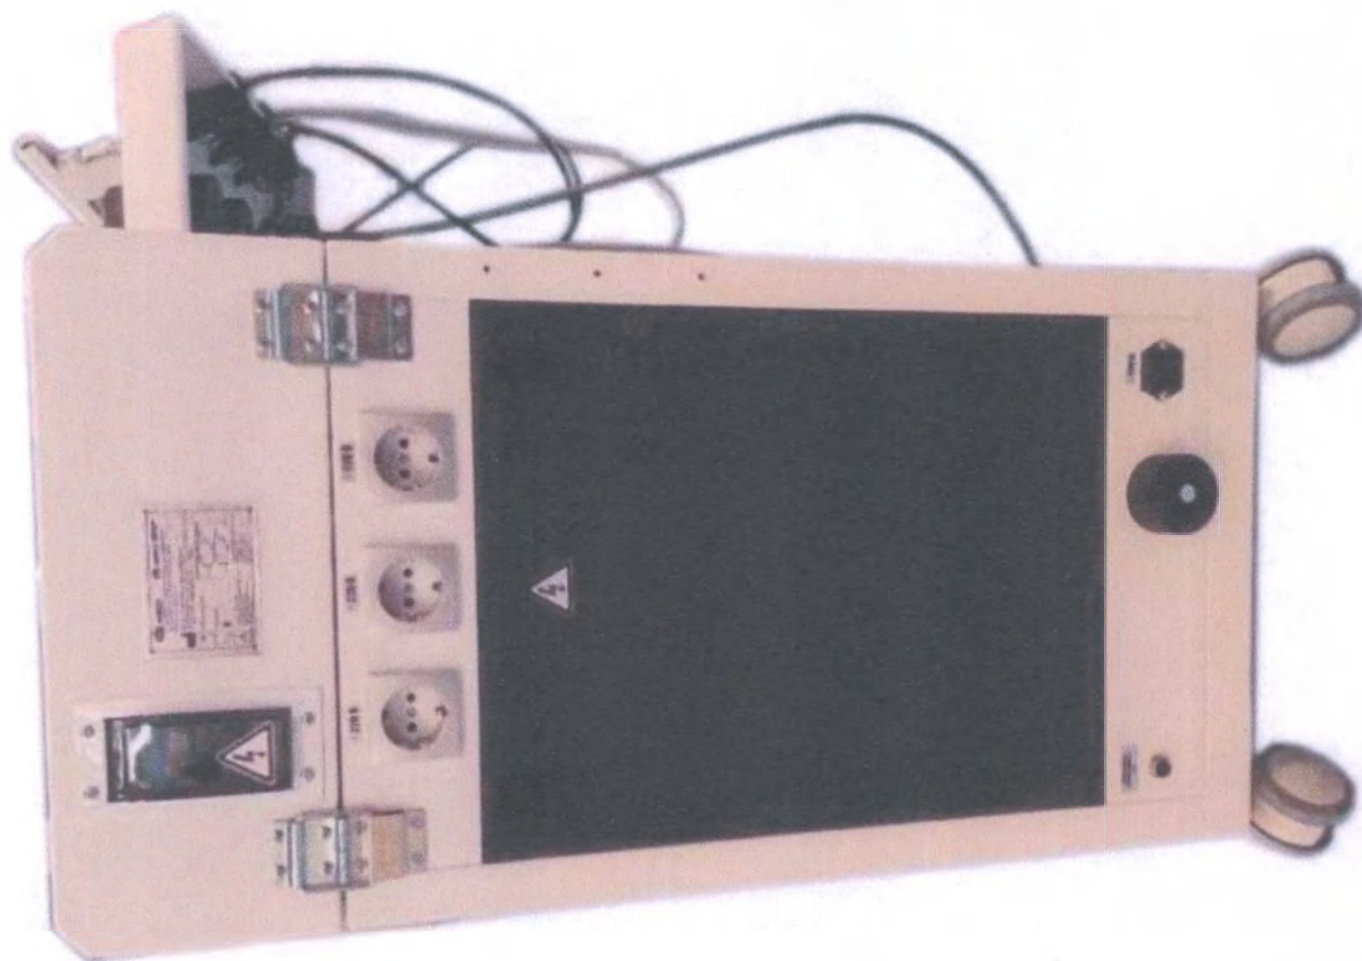

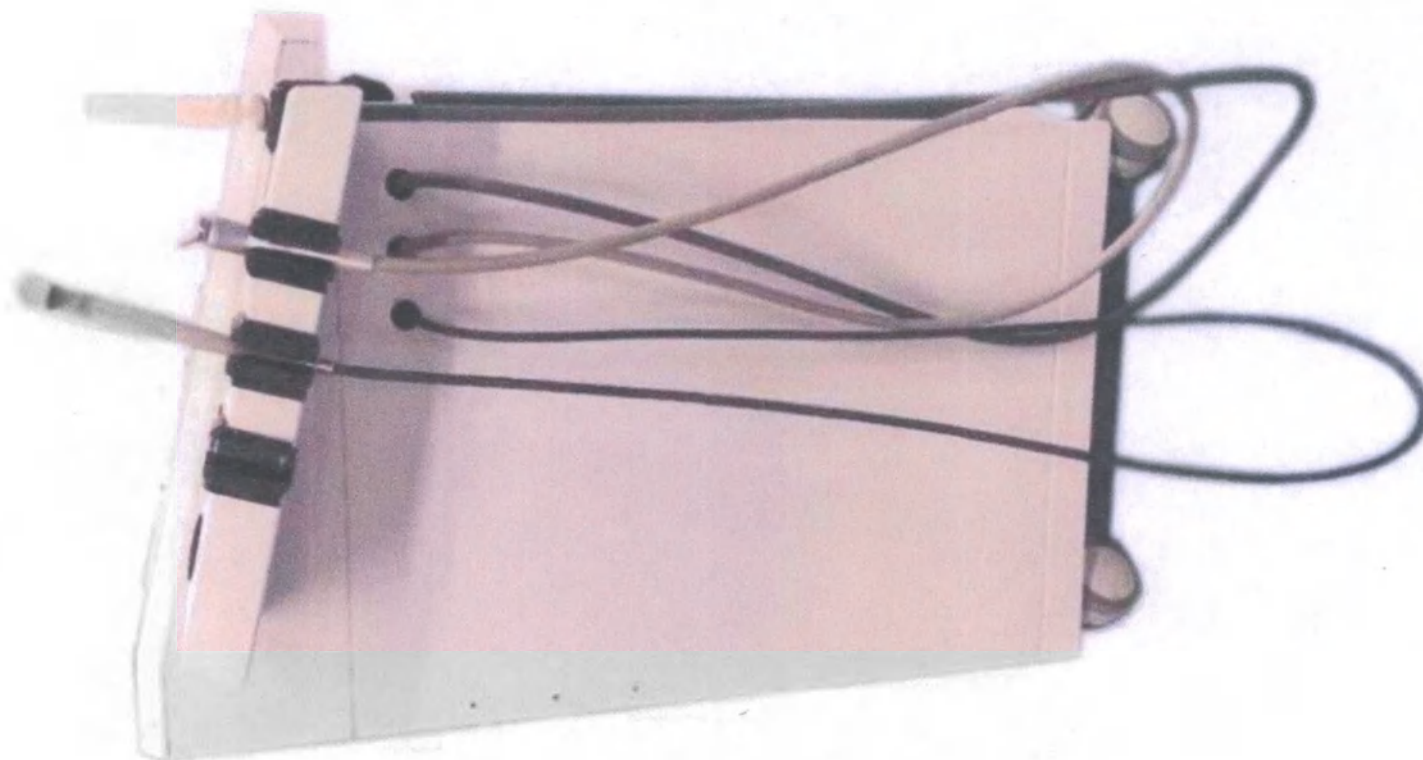

Установка оториноларингологическая DS.AssistENT по ТУ 32.50.50-002-86671063-2022 вариант исполнения Compact, вид сверху



Шнур сетевого питания,

Смотри фото на стр. 6

Емкость накопительная для секрета

Смотри фото на стр. 11-12

Адаптер олив

Смотри фото на стр. 13

Оливы конусообразные из оргстекла разных типоразмеров: диаметр 8 мм, диаметр 11 мм, диаметр 15 мм, диаметр 20 мм

Смотри фото на стр. 14

Оливы конусообразные металлические разных типоразмеров: диаметр 8мм, диаметр 11 мм, диаметр 15мм, диаметр 20мм

Смотри фото на стр. 15

Комплект для аспирации и промывания миндалин в составе: рукоятка, колпачок

Смотри фото на стр. 16

Канюля для аспирации разных типоразмеров: диаметр 1,8 мм, диаметр 3 мм, диаметр 3,5 мм, диаметр 4мм

Смотри фото на стр. 17

Пистолет воздушный для использования с насадками-распылителями лекарственных средств: с пластиковым курком или с металлическим курком или без курка

Смотри фото на стр. 22-24

Насадка - распылитель жидких лекарственных средств (прямая): для пистолета воздушного с пластиковым курком или для пистолета воздушного с металлическим курком или для пистолета воздушного без курка,

Смотри фото на стр. 25-27

Насадка - распылитель жидких лекарственных средств (изогнутая): для пистолета воздушного с пластиковым курком или для пистолета воздушного с металлическим курком или для пистолета воздушного без курка,

Смотри фото на стр. 28-30

Насадка - распылитель маслянистых лекарственных средств (прямая): для пистолета воздушного с пластиковым курком или для пистолета воздушного с металлическим курком или для пистолета воздушного без курка,

Смотри фото на стр. 31-33

Насадка - распылитель порошковых лекарственных средств (прямая): для пистолета воздушного с пластиковым курком или для пистолета воздушного с металлическим курком или для пистолета воздушного без курка,

Смотри фото на стр. 34-36

Емкость для лекарственных средств для пистолета воздушного с пластиковым курком объемом 30 мл или для пистолета воздушного с металлическим курком объемом 60 мл или для пистолета воздушного без курка объемом 30 мл,


Смотри фото на стр. 37-39

Тюльпан для промывания уха Смотри фото на стр. 73

Насадка-сопло для впрыскивания воды под давлением Смотри фото на стр. 74

Защита от брызг Смотри фото на стр. 75

Резервуар для системы промывания полостей объемом 3л

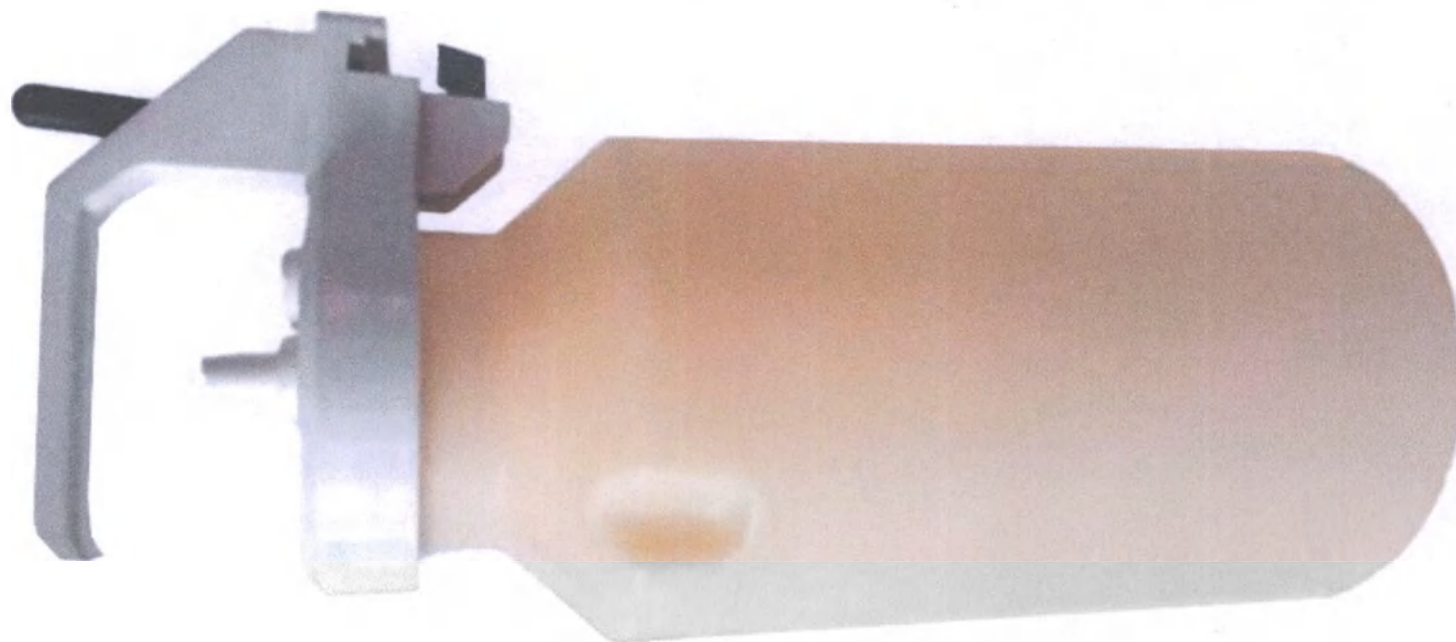

Кресло пациента электромеханическое

Смотри фото на стр. 40

Блок управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD 3in1 с интегрированным видеодисплеем, источником света, камерой, адаптером эндоскопа, адаптером питания

Смотри фото на стр. 41-45

Блок управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD с видеомонитором, источником света, камерой

Смотри фото на стр. 46-49

Источник света DS.Vision Light с фиброкабелем

Смотри фото на стр. 50

Кабель питания для кресла пациента электромеханического

Смотри фото на стр. 51

Кабель соединительный для кресла пациента электромеханического

Смотри фото на стр. 52

Кабель соединительный для блока управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD 3in1

Смотри фото на стр. 53

Кабель соединительный для блока управления эндоскопической визуализации DS.Vision FHD

Смотри фото на стр. 54

Кабель соединительный для источника света DS.Vision Light с фиброкабелем

Смотри фото на стр. 55

Педальный выключатель Смотри фото на стр. 56

Кабель DVI Смотри фото на стр. 57

Кабель CVBS Смотри фото на стр. 58

Кабель HDMI Смотри фото на стр. 59

Кабель SDI Смотри фото на стр. 60

Стойка приборная DS.T-2-04 Смотри фото на стр. 61

Стойка приборная DS.T-3-07 Смотри фото на стр. 62

Стойка приборная DS.T-4-03 Смотри фото на стр. 63

Стойка приборная DS.T-2-05 Смотри фото на стр. 64

Стойка приборная DS.T-3-08 Смотри фото на стр. 65

Стойка приборная DS.T-4-04 Смотри фото на стр. 66

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Штанга из алюминия




Штанга из стали



Кронштейн крепления штанги из алюминия к установке



Кронштейн крепления штанги из стали к установке

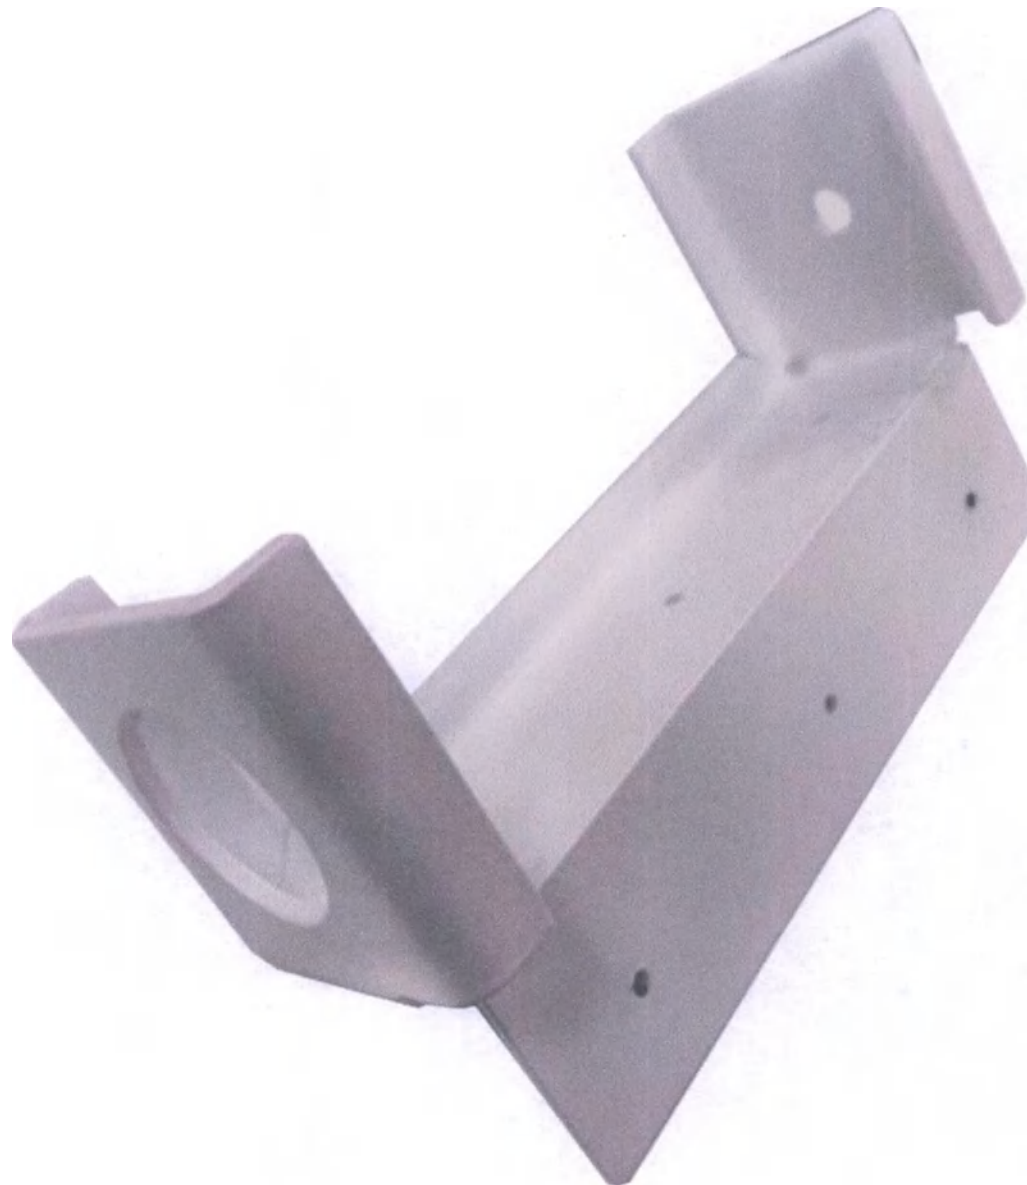

Полка для дополнительного оборудования




Кронштейн крепления полки для дополнительного оборудования




Кронштейн для крепления монитора




Держатель VESA для монитора или видеосистемы

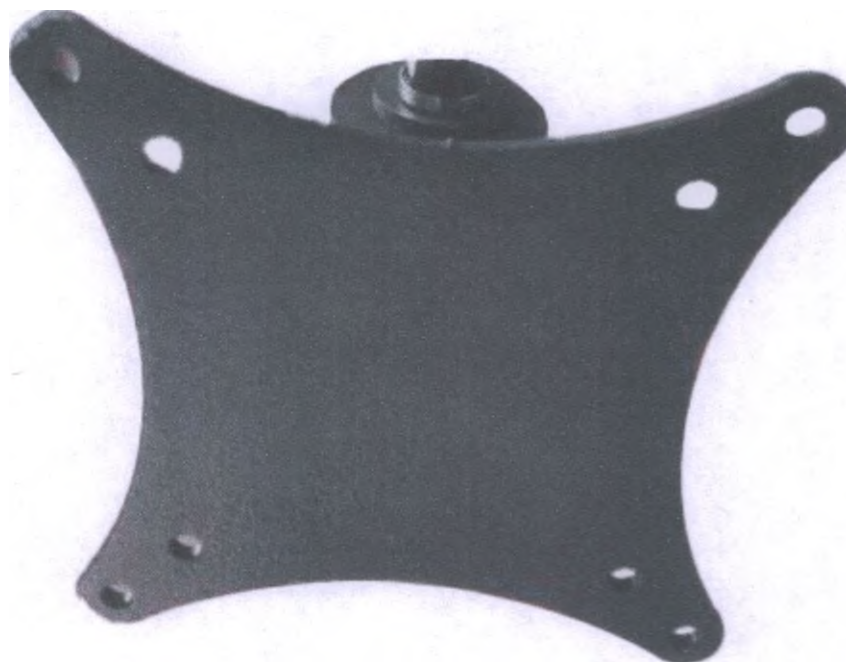

Стул врача

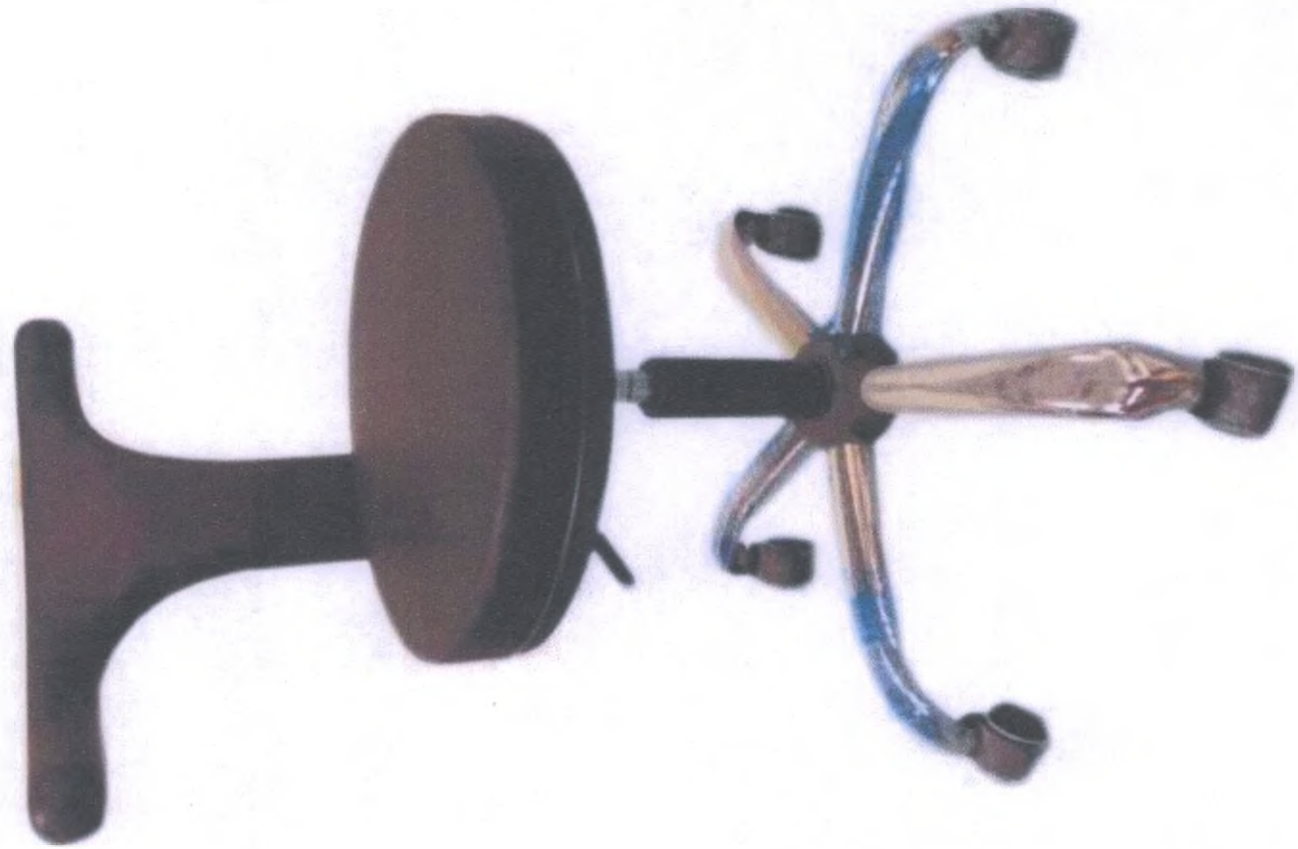


Полка с четырьмя металлическими банками объемом 350 мл для инструментов и лекарственных средств

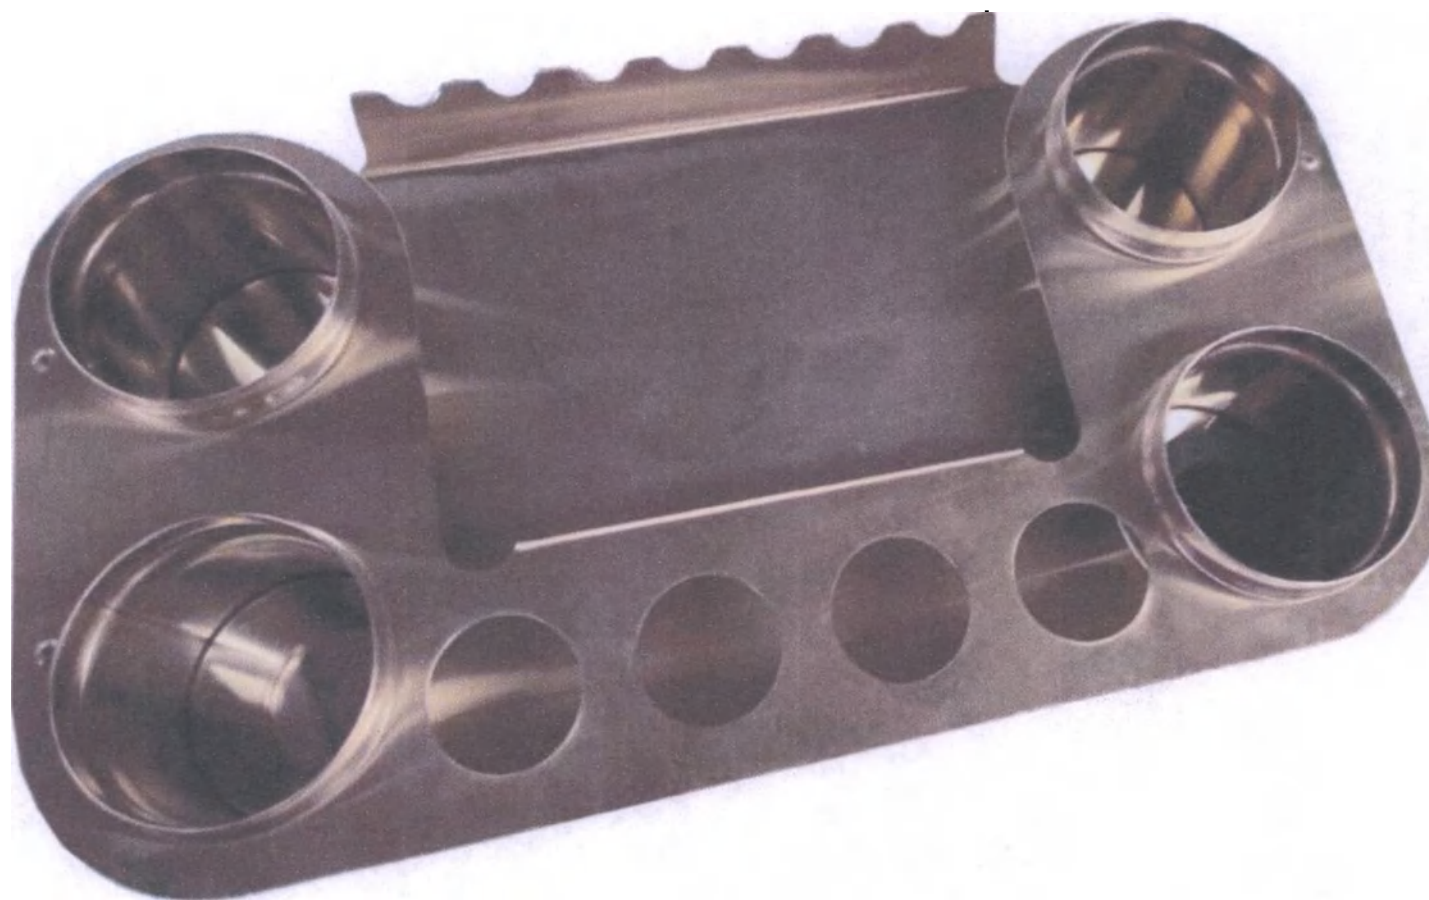


Баночка для лекарственных средств с притертой крышкой объемом 30 мл



Полка с пятью лотками металлическими для инструментов

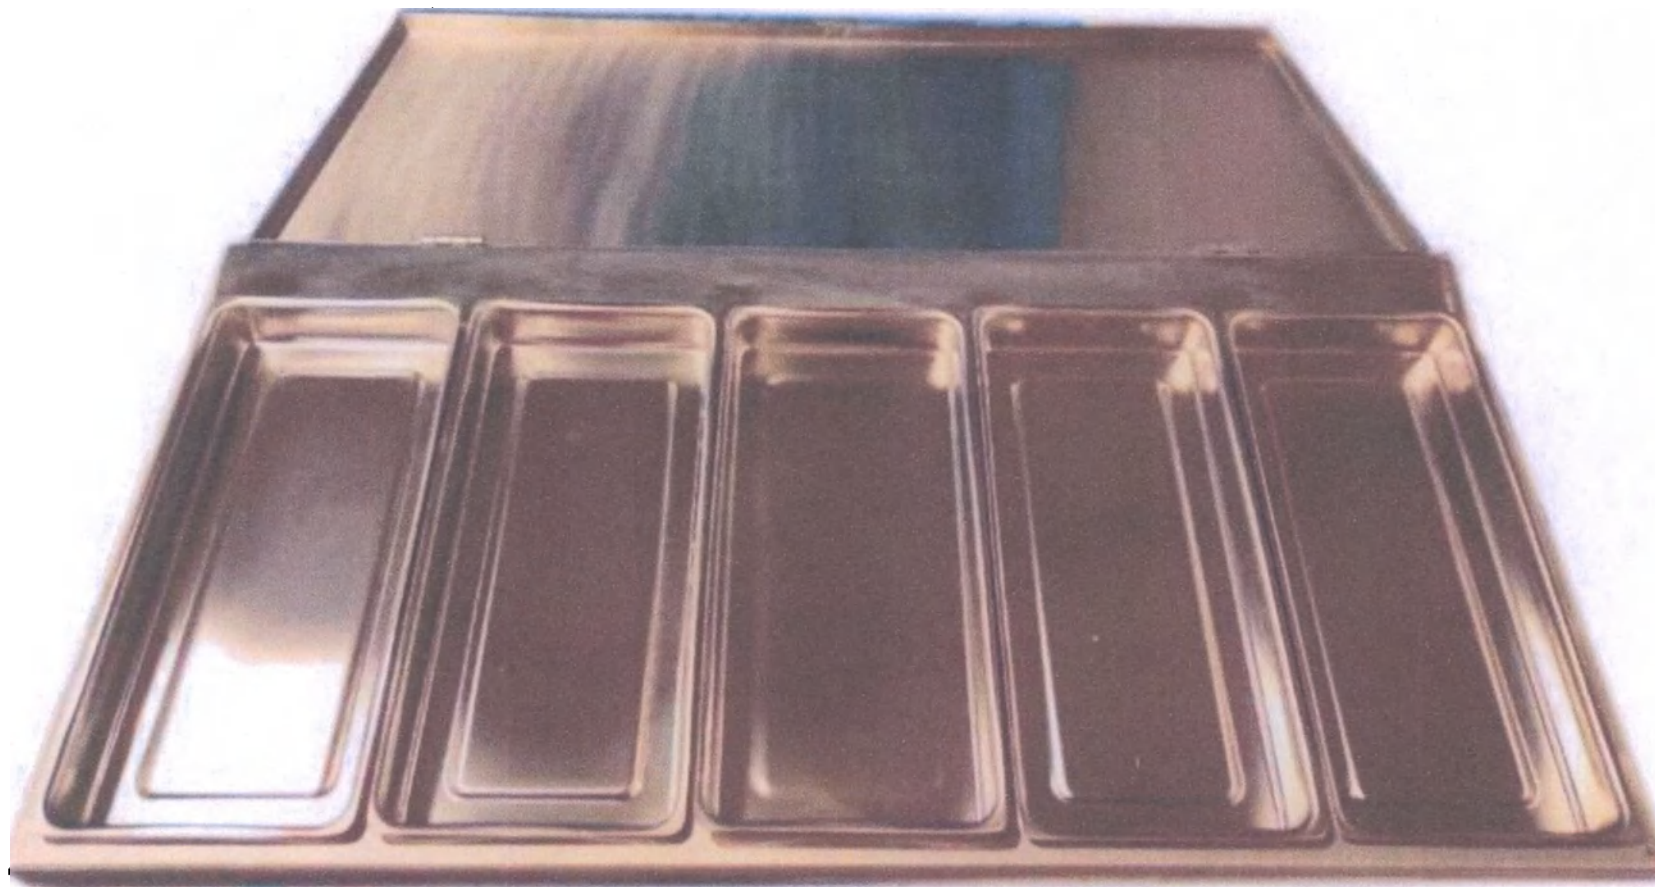

Полка с четырьмя банками объемом 350 мл для инструментов и лекарственных средств с посадочным местом для держателей эндоскопов

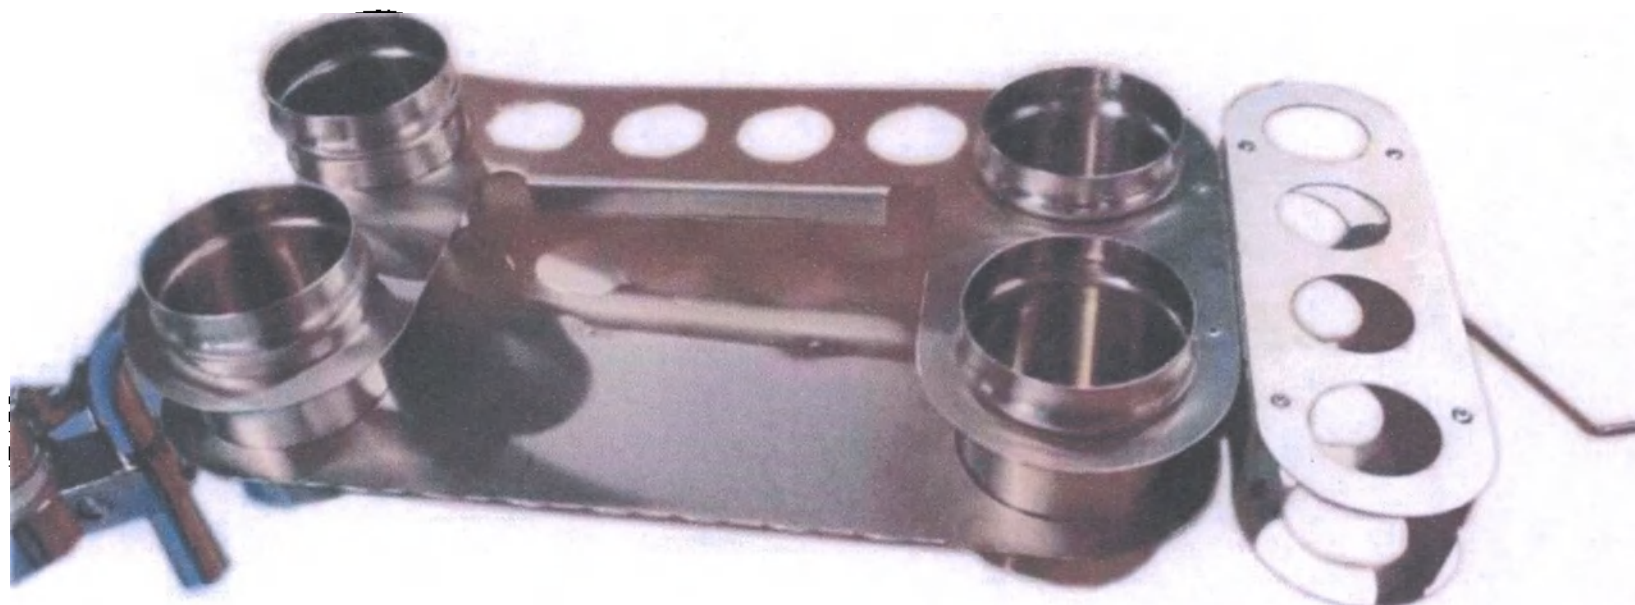


держатель жестких эндоскопов металлический



держатель гибких эндоскопов металлический




Держатель камеры

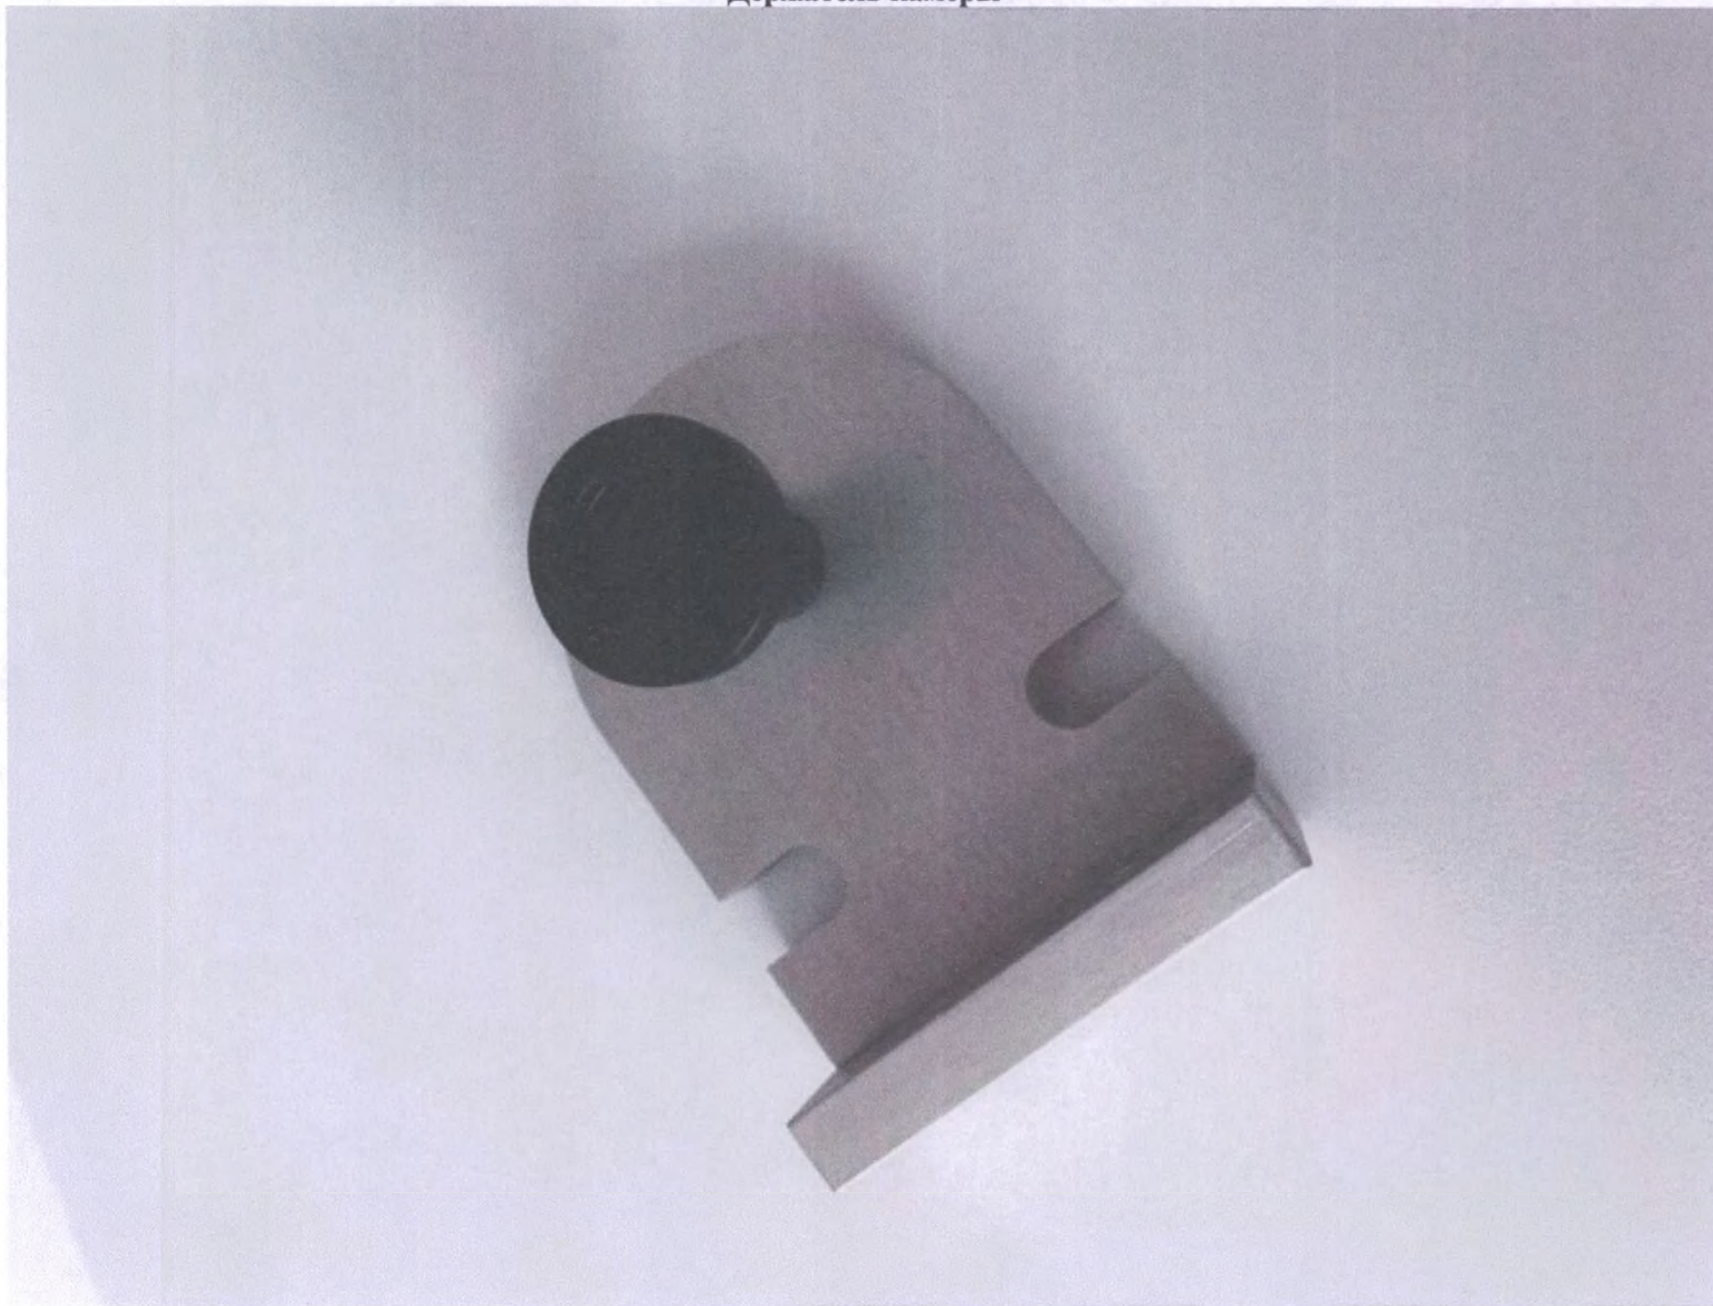

Кронштейн крепления налобного фонаря



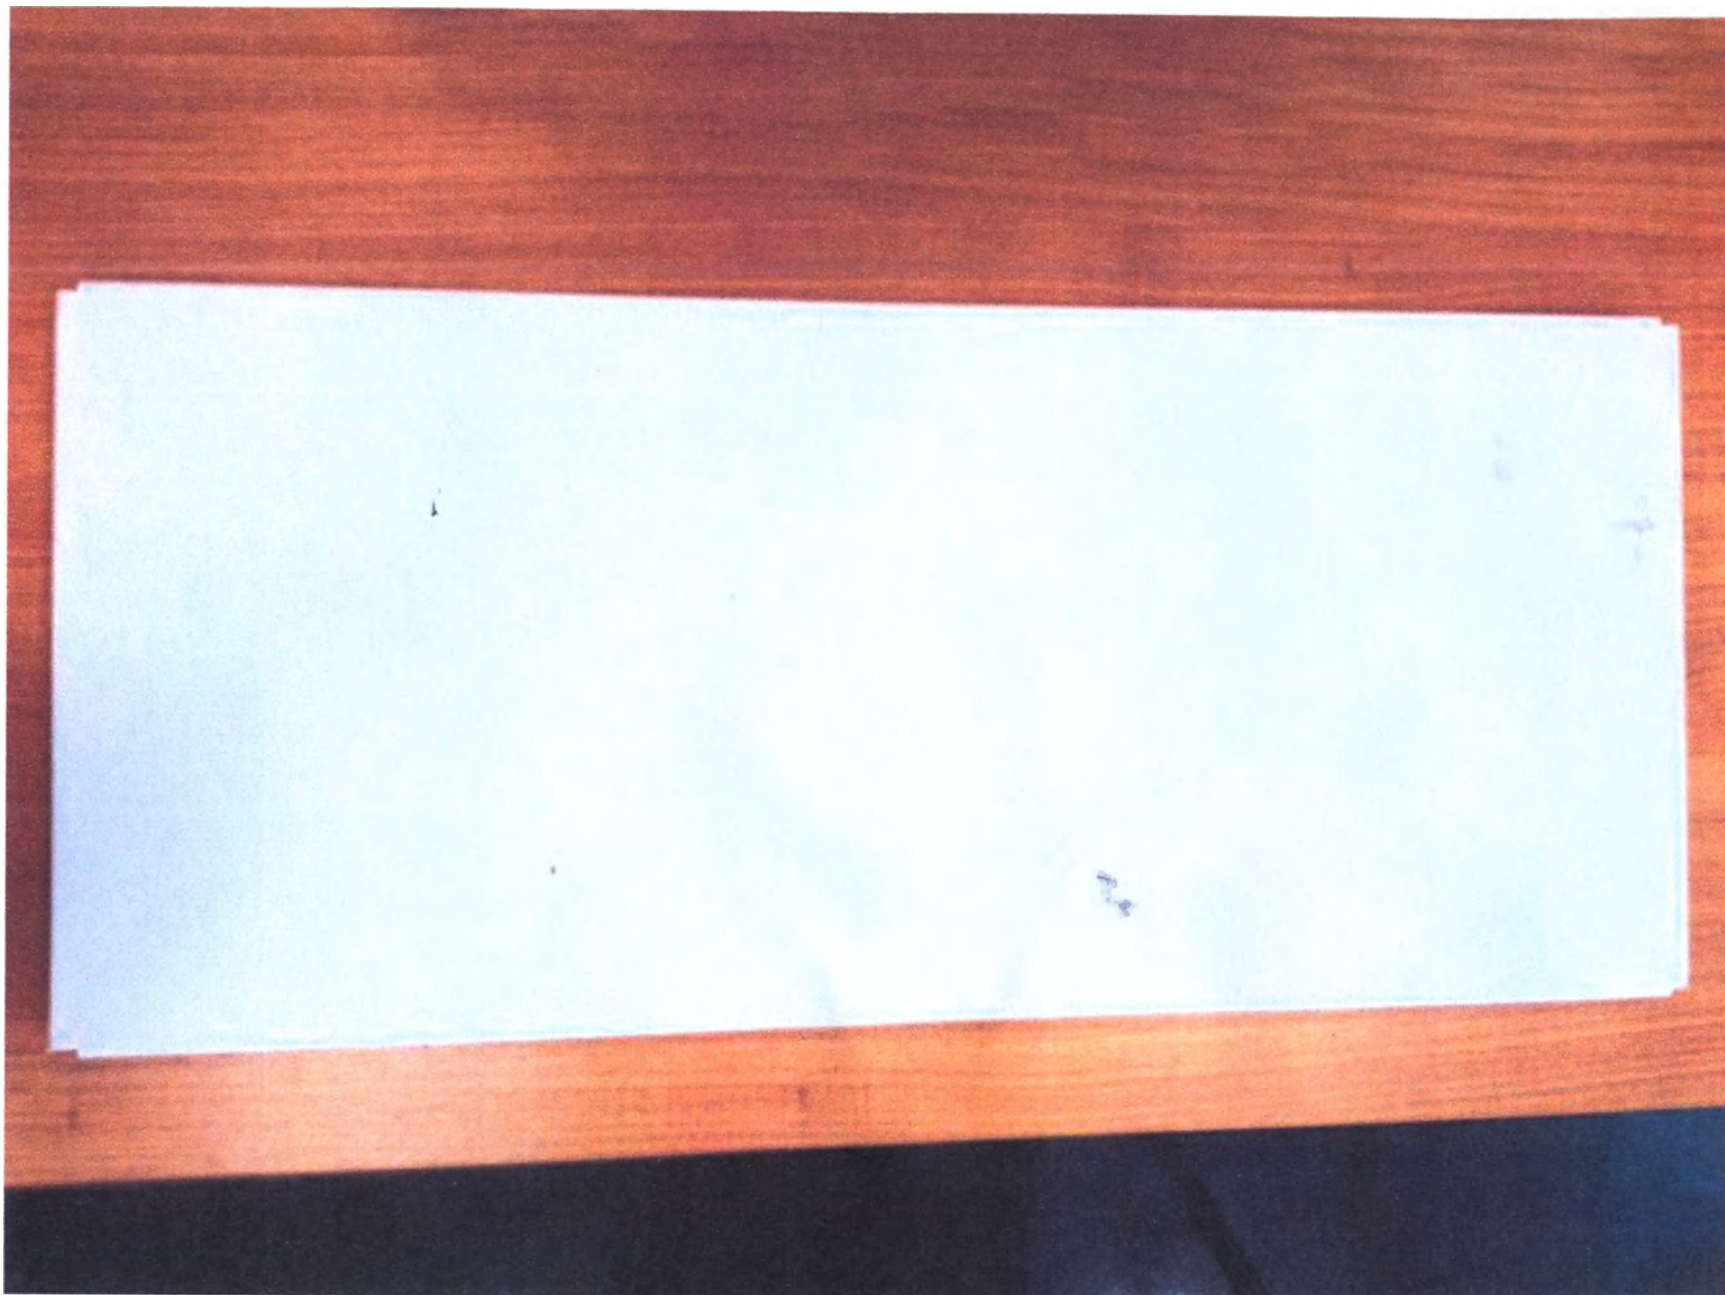

информация по работе

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

103 (сто три) листов
цифрами прописью

Должность инженер

Подпись Юлия Голубайнова

«29» октября 2023 г. М.П.

