

Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮМЕН ТЕХНОЛОГИИ»

399054, Липецкая область, м. р-н Грязинский, г.п. город Грязи, г. Грязи, ул. Есенина, д. 68
ИНН/КПП-4802014245/480201001, ОГРН-1214800013735

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:**

**«Устройство компрессии лучевой артерии NewMan
по ТУ 32.50.13-001-70849843-2022»**

2023г.



Рис.1. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия: «Устройство компрессии лучевой артерии NewMap по ТУ 32.50.13-001-70849843-2022», вариант исполнения: Устройство компрессии лучевой артерии NewMap с двумя баллонами – 24см.
Фото изделия без упаковки.

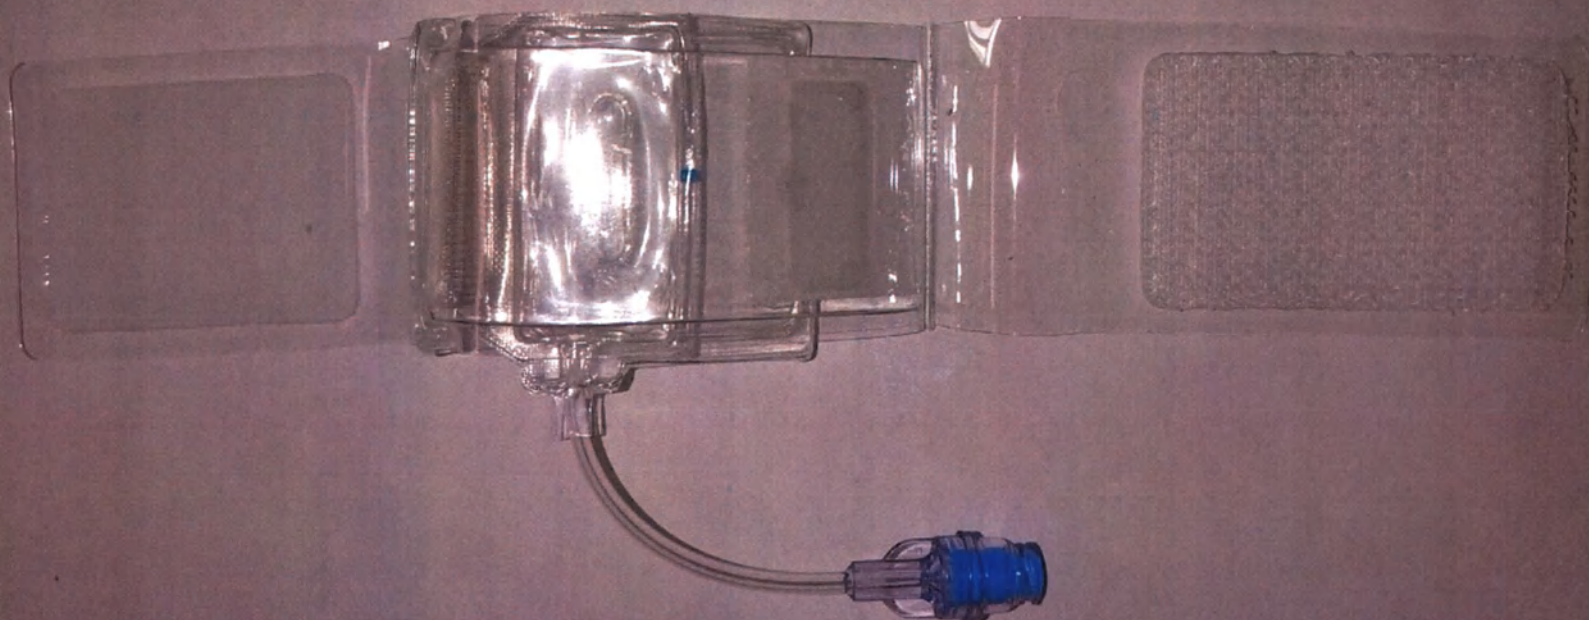


Рис.2. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия: «Устройство компрессии лучевой артерии NewMan по ТУ 32.50.13-001-70849843-2022», вариант исполнения: Устройство компрессии лучевой артерии NewMan с одним баллоном – 29см. Фото изделия без упаковки.



Рис.3. Фотографическое изображение общего вида: Широко-инфльтор. Входит в состав медицинского изделия: «Устройство компрессии лучевой артерии NewMap по ТУ 32.50.13-001-70849843-2022». Фото изделия без упаковки.

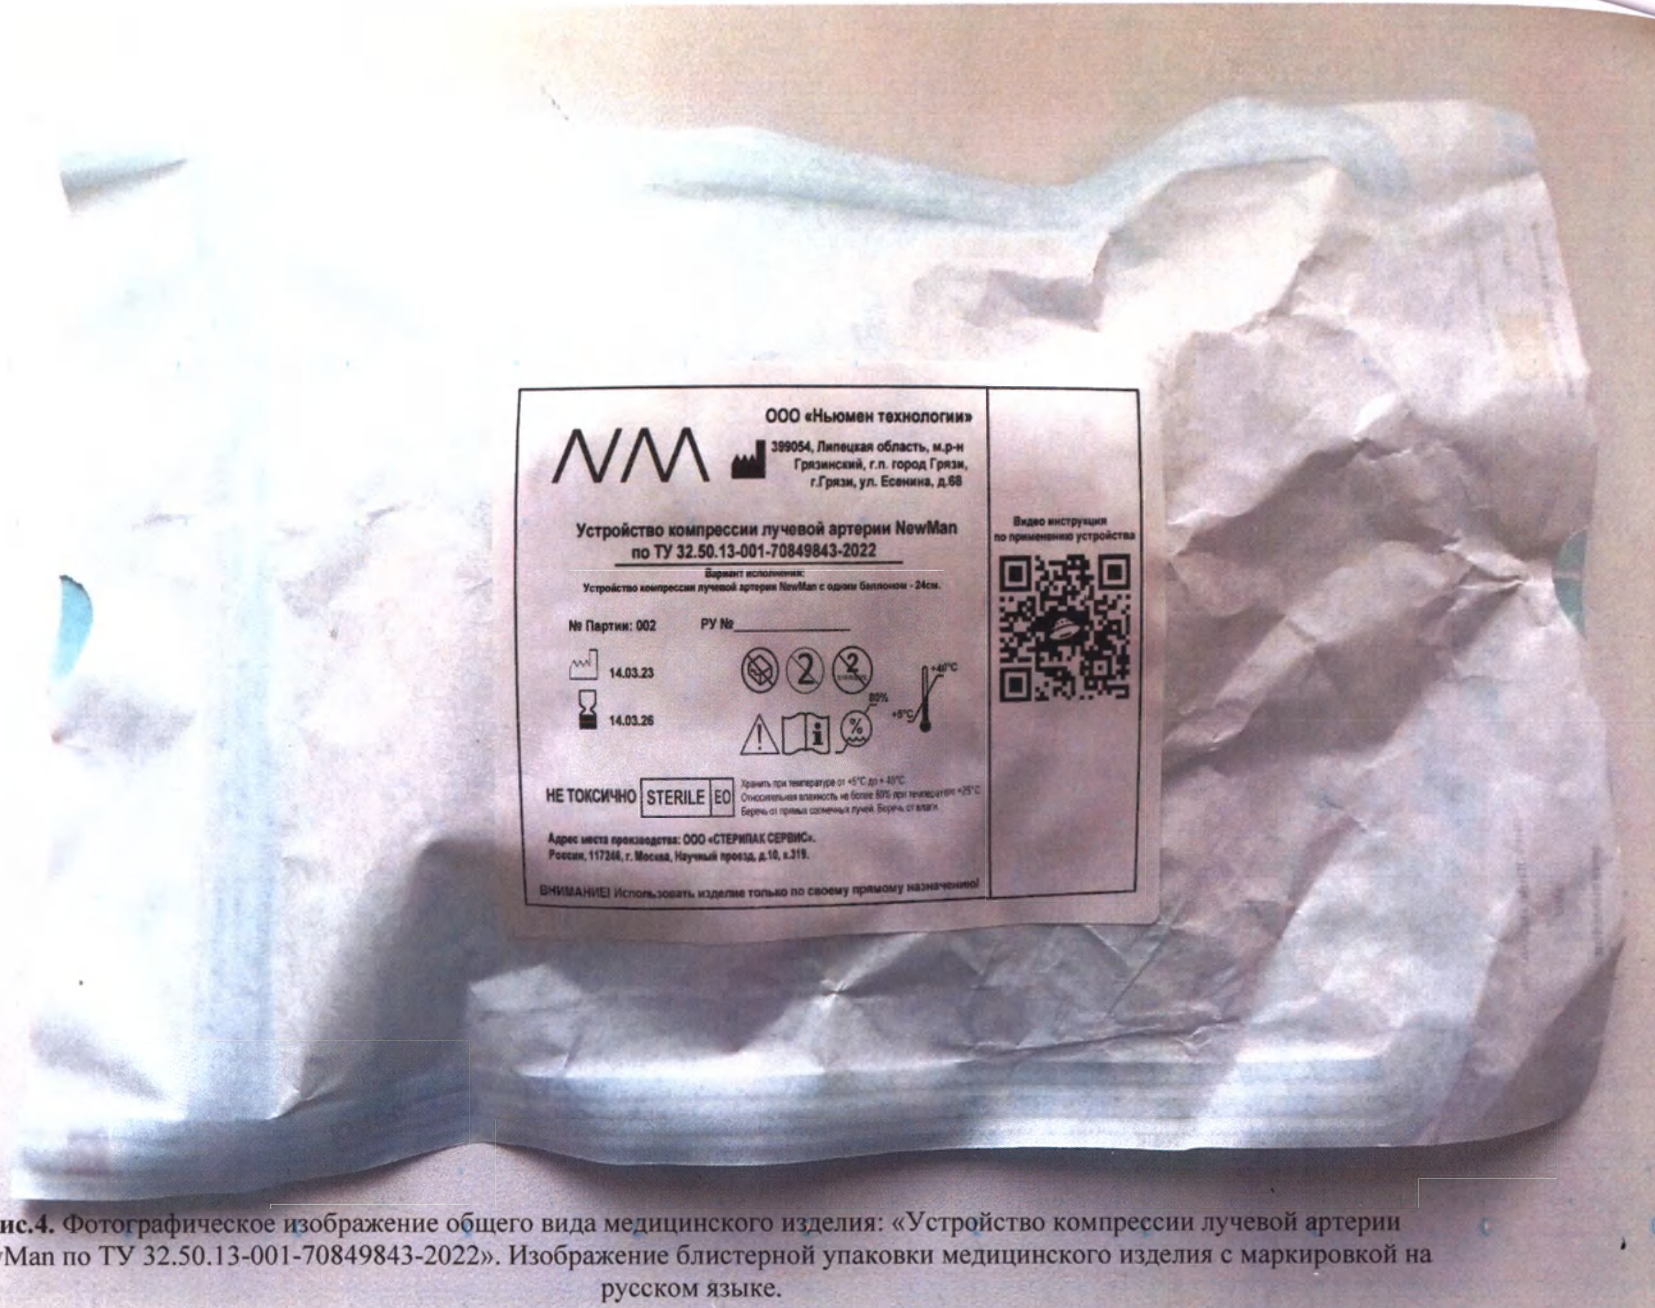


Рис.4. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия: «Устройство компрессии лучевой артерии NewMan по ТУ 32.50.13-001-70849843-2022». Изображение blisterной упаковки медицинского изделия с маркировкой на русском языке.



Рис.5. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия: «Устройство компрессии лучевой артерии NewMan по ТУ 32.50.13-001-70849843-2022», вариант исполнения: Устройство компрессии лучевой артерии NewMan с одним баллоном – 24см. Фото изделия в блистерной упаковке.



Рис.6.
 Фотографическое
 изображение общего
 вида медицинского
 изделия:
 «Устройство
 компрессии лучевой
 артерии NewMan по
 ТУ 32.50.13-001-
 70849843-2022».
 Фотографическое
 изображение
 групповой упаковки
 медицинского
 изделия.



ООО «Ньюмен технологии»



399054, Липецкая область, м.р-н
Грязинский, г.п. город Грязи,
г.Грязи, ул. Есенина, д.68

**Устройство компрессии лучевой артерии NewMan
по ТУ 32.50.13-001-70849843-2022**

Вариант исполнения:

Устройство компрессии лучевой артерии NewMan с двумя баллонами - 24см.

№ Партии: 002




14.03.23



14.03.26

Количество: 10шт.


РУ № _____



80%



+5°C



+40°C

НЕ ТОКСИЧНО

STERILE

EO

Хранить при температуре от +5°C до +40°C.
Относительная влажность не более 80% при температуре +25°C.
Беречь от прямых солнечных лучей. Беречь от влаги.

Адрес места производства: ООО «СТЕРИПАК СЕРВИС».
Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.10, к.319.

ВНИМАНИЕ! Использовать изделие только по своему прямому назначению!

Видео инструкция
по применению устройства



Масса НЕТТО: 405г
Масса БРУТТО: 455г

Рис.7. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия: «Устройство компрессии лучевой артерии NewMan по ТУ 32.50.13-001-70849843-2022». Фотографическое изображение стикера с маркировкой на групповой упаковке медицинского изделия.

Рис.8. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия: «Устройство компрессии лучевой артерии NewMan по ТУ 32.50.13-001-70849843-2022».

Фотографическое изображение стикера с маркировкой на транспортной упаковке медицинского изделия.



НМ ООО «Ньюмен технологии»
399054, Липецкая область, м.р-н
Грязинский, г.п. город Грязи,
г.Грязи, ул. Есенина, д.88

Устройство компрессии лучевой артерии NewMap
по ТУ 32.50.13-001-70849843-2022

Вариант исполнения:
Устройство компрессии лучевой артерии NewMap с одним баллоном - 29см.

№ Партии: _____ РУ № _____

Упаковщик № _____

Масса НЕТТО: _____
Масса БРУТТО: _____

Количество: _____

НЕ ТОКСИЧНО STERILE EO

Хранить при температуре от +5°C до +40°C.
Относительная влажность не более 80% при температуре +25°C.
Бережь от прямых солнечных лучей. Бережь от влаги.

Адрес места производства: ООО «СТЕРИПАК СЕРВИС»
Россия, 117248, г. Москва, Научный проезд, д.10, к.319.

МЕСТО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШТРИХ - КОДА

Рис.9. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия: «Устройство компрессии лучевой артерии NewMap по ТУ 32.50.13-001-70849843-2022». Увеличенное фотографическое изображение стикера с маркировкой на транспортной упаковке медицинского изделия.

СЕРТИФИКАТ

Здесь
указывается
метамбо
10 штук
Октябрь 2018 г.



Общество с ограниченной ответственностью «НЬЮМЕН ТЕХНОЛОГИИ»

119571, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО, ПР-КТ
ВЕРНАДСКОГО, Д. 96
ИНН/КПП-4802014245/480201001, ОГРН-1214800013735

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «НЬЮМЕН ТЕХНОЛОГИИ»

Огнерубов Д.В.

12.07. 2023 г.

Макеты маркировки медицинского изделия

«Устройство компрессии лучевой артерии NewMan»
по ТУ 32.50.13-001-70849843-2022»

2023г.

Макет маркировки индивидуальной (блистерной) упаковки медицинского изделия:
Устройство компрессии лучевой артерии NewMap с двумя баллонами – 24см

 ООО «Ньюмен технологии» 119571, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 96 Устройство компрессии лучевой артерии NewMap по ТУ 32.50.13-001-70849843-2022 Вариант исполнения: Устройство компрессии лучевой артерии NewMap с двумя баллонами - 24см. № Партии: _____ РУ № _____  НЕ ТОКСИЧНО STERILE EO Хранить при температуре от +5°C до +40°C. Относительная влажность не более 80% при температуре +25°C. Беречь от прямых солнечных лучей. Беречь от влаги. Адрес места производства: ООО «СТЕРИПАК СЕРВИС». Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.10, к.319. ВНИМАНИЕ! Использовать изделие только по своему прямому назначению!	Видео инструкция по применению устройства 
---	--

Макет маркировки индивидуальной (блистерной) упаковки медицинского изделия:
Устройство компрессии лучевой артерии NewMap с двумя баллонами – 29см

 ООО «Ньюмен технологии» 119571, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 96 Устройство компрессии лучевой артерии NewMap по ТУ 32.50.13-001-70849843-2022 Вариант исполнения: Устройство компрессии лучевой артерии NewMap с двумя баллонами - 29см. № Партии: _____ РУ № _____  НЕ ТОКСИЧНО STERILE EO Хранить при температуре от +5°C до +40°C. Относительная влажность не более 80% при температуре +25°C. Беречь от прямых солнечных лучей. Беречь от влаги. Адрес места производства: ООО «СТЕРИПАК СЕРВИС». Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.10, к.319. ВНИМАНИЕ! Использовать изделие только по своему прямому назначению!	Видео инструкция по применению устройства 
---	--

ООО «Ньюмен технологии»

119571, Г. МОСКВА,
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО,
ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 96

Устройство компрессии лучевой артерии NewMap
по ТУ 32.50.13-001-70849843-2022

Вариант исполнения:
Устройство компрессии лучевой артерии NewMap с одним баллоном - 24см.

№ Партии: _____

ПУ № _____

НЕ ТОКСИЧНО

STERILE

EO

Хранить при температуре от +5°C до +40°C.
Относительная влажность не более 80% при температуре +25°C.
Беречь от прямых солнечных лучей. Беречь от влаги.

Адрес места производства: ООО «СТЕРИПАК СЕРВИС».
Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.10, к.319.

Видео инструкция
по применению устройства

ВНИМАНИЕ! Использовать изделие только по своему прямому назначению!

ООО «Ньюмен технологии»

119571, Г.МОСКВА,
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО,
ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 96

Устройство компрессии лучевой артерии NewMap
по ТУ 32.50.13-001-70849843-2022

Вариант исполнения:
 Устройство компрессии лучевой артерии NewMap с одним баллоном - 29см.

№ Партии:

ПУ № _____

НЕ ТОКСИЧНО

STERILE

EO

Хранить при температуре от +5°C до +40°C.
 Относительная влажность не более 80% при температуре +25°C.
 Беречь от прямых солнечных лучей. Беречь от влаги.

Адрес места производства: ООО «СТЕРИПАК СЕРВИС».
 Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.10, к.319.

Видео инструкция
по применению устройства

ВНИМАНИЕ! Использовать изделие только по своему прямому назначению!

Макет маркировки групповой упаковки медицинского изделия:
Устройство компрессии лучевой артерии NewMap с двумя баллонами – 24см

		ООО «Ньюмен технологии» 119571, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 96	
Устройство компрессии лучевой артерии NewMap по ТУ 32.50.13-001-70849843-2022			
Вариант исполнения: Устройство компрессии лучевой артерии NewMap с двумя баллонами - 24см.			
№ Партии:  Количество:	РУ № _____		
НЕ ТОКСИЧНО	STERILE	EO	Хранить при температуре от +5°C до +40°C. Относительная влажность не более 80% при температуре +25°C. Беречь от прямых солнечных лучей. Беречь от влаги.
Адрес места производства: ООО «СТЕРИПАК СЕРВИС». Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.10, к.319.			Видео инструкция по применению устройства  
ВНИМАНИЕ! Использовать изделие только по своему прямому назначению!			Масса НЕТТО: Масса БРУТТО:

Макет маркировки групповой упаковки медицинского изделия:
Устройство компрессии лучевой артерии NewMap с двумя баллонами – 29см

		ООО «Ньюмен технологии» 119571, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 96	
Устройство компрессии лучевой артерии NewMap по ТУ 32.50.13-001-70849843-2022			
Вариант исполнения: Устройство компрессии лучевой артерии NewMap с двумя баллонами - 29см.			
№ Партии:  Количество:	РУ № _____		
НЕ ТОКСИЧНО	STERILE	EO	Хранить при температуре от +5°C до +40°C. Относительная влажность не более 80% при температуре +25°C. Беречь от прямых солнечных лучей. Беречь от влаги.
Адрес места производства: ООО «СТЕРИПАК СЕРВИС». Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.10, к.319.			Видео инструкция по применению устройства  
ВНИМАНИЕ! Использовать изделие только по своему прямому назначению!			Масса НЕТТО: Масса БРУТТО:

Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия:

		ООО «Ньюмен технологии»	
		 119571, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, Д. 96	
Устройство компрессии лучевой артерии NewMap по ТУ 32.50.13-001-70849843-2022			
Вариант исполнения: Устройство компрессии лучевой артерии NewMap с одним баллоном - 29см.			
№ Партии: _____	ПУ № _____		
 _____	 _____		
Количество: _____	  		
	  		
НЕ ТОКСИЧНО STERILE EO		 +40°C +5°C	
		 80%	
Адрес места производства: ООО «СТЕРИПАК СЕРВИС». Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д.10, к.319.		МЕСТО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШТРИХ - КОДА	
		  	
		Упаковщик № _____ Масса НЕТТО: _____ Масса БРУТТО: _____	

Всего произведено и
сдано сертификатов

5 (четыре)
штук

Однорядов Д.В.

