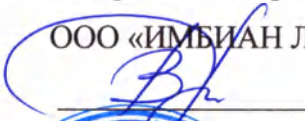


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

  
/В.В. Осипова/

23 апреля 2023 г.



**Фотографические изображения общего вида**

**Набор реагентов для качественного иммуноферментного подтверждения антител класса  
М и G к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме и препаратах крови  
«ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА»  
по ТУ 21.20.23-463-41390295-2023**

## Комплект №1



**ВГС-MG-**  
**подтверждающий-**  
**ИМБИАН-ИФА**  
Комплект №1

**Набор реагентов для качественного иммуноферментного подтверждения антител класса М и G к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме и препаратах крови «ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-463-41390295-2023**  
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

- 1 Иммуносорбент
- 2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец, 1,0 мл
- 3 К(-) - отрицательный контрольный образец, 2,0 мл
- 4 ФСБ-Т - концентрат промывочного раствора, 50,0 мл
- 5 РРО - раствор для разведения образцов, 13,0 мл
- 6 РК - раствор конъюгата, 13,0 мл
- 7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина, 13,0 мл
- 8 Стоп-реагент, 13,0 мл
- 9 Пленка для заклеивания планшета
- 10 Ванночка
- 11 Наконечник
- 12 Инструкция по применению

- 1 шт.
- 1 фл.
- 1 фл.
- 1 фл.
- 1 фл.
- 1 фл.
- 1 фл.
- 1 фл.
- 3 шт.
- 3 шт.
- 24 шт.
- 1 шт.

**ПУ №**

**LOT**

230301

**REF**

VE-014/48.1

**EXP**

2023-03-01

**EXP**

2025-05-01

**Imbian**



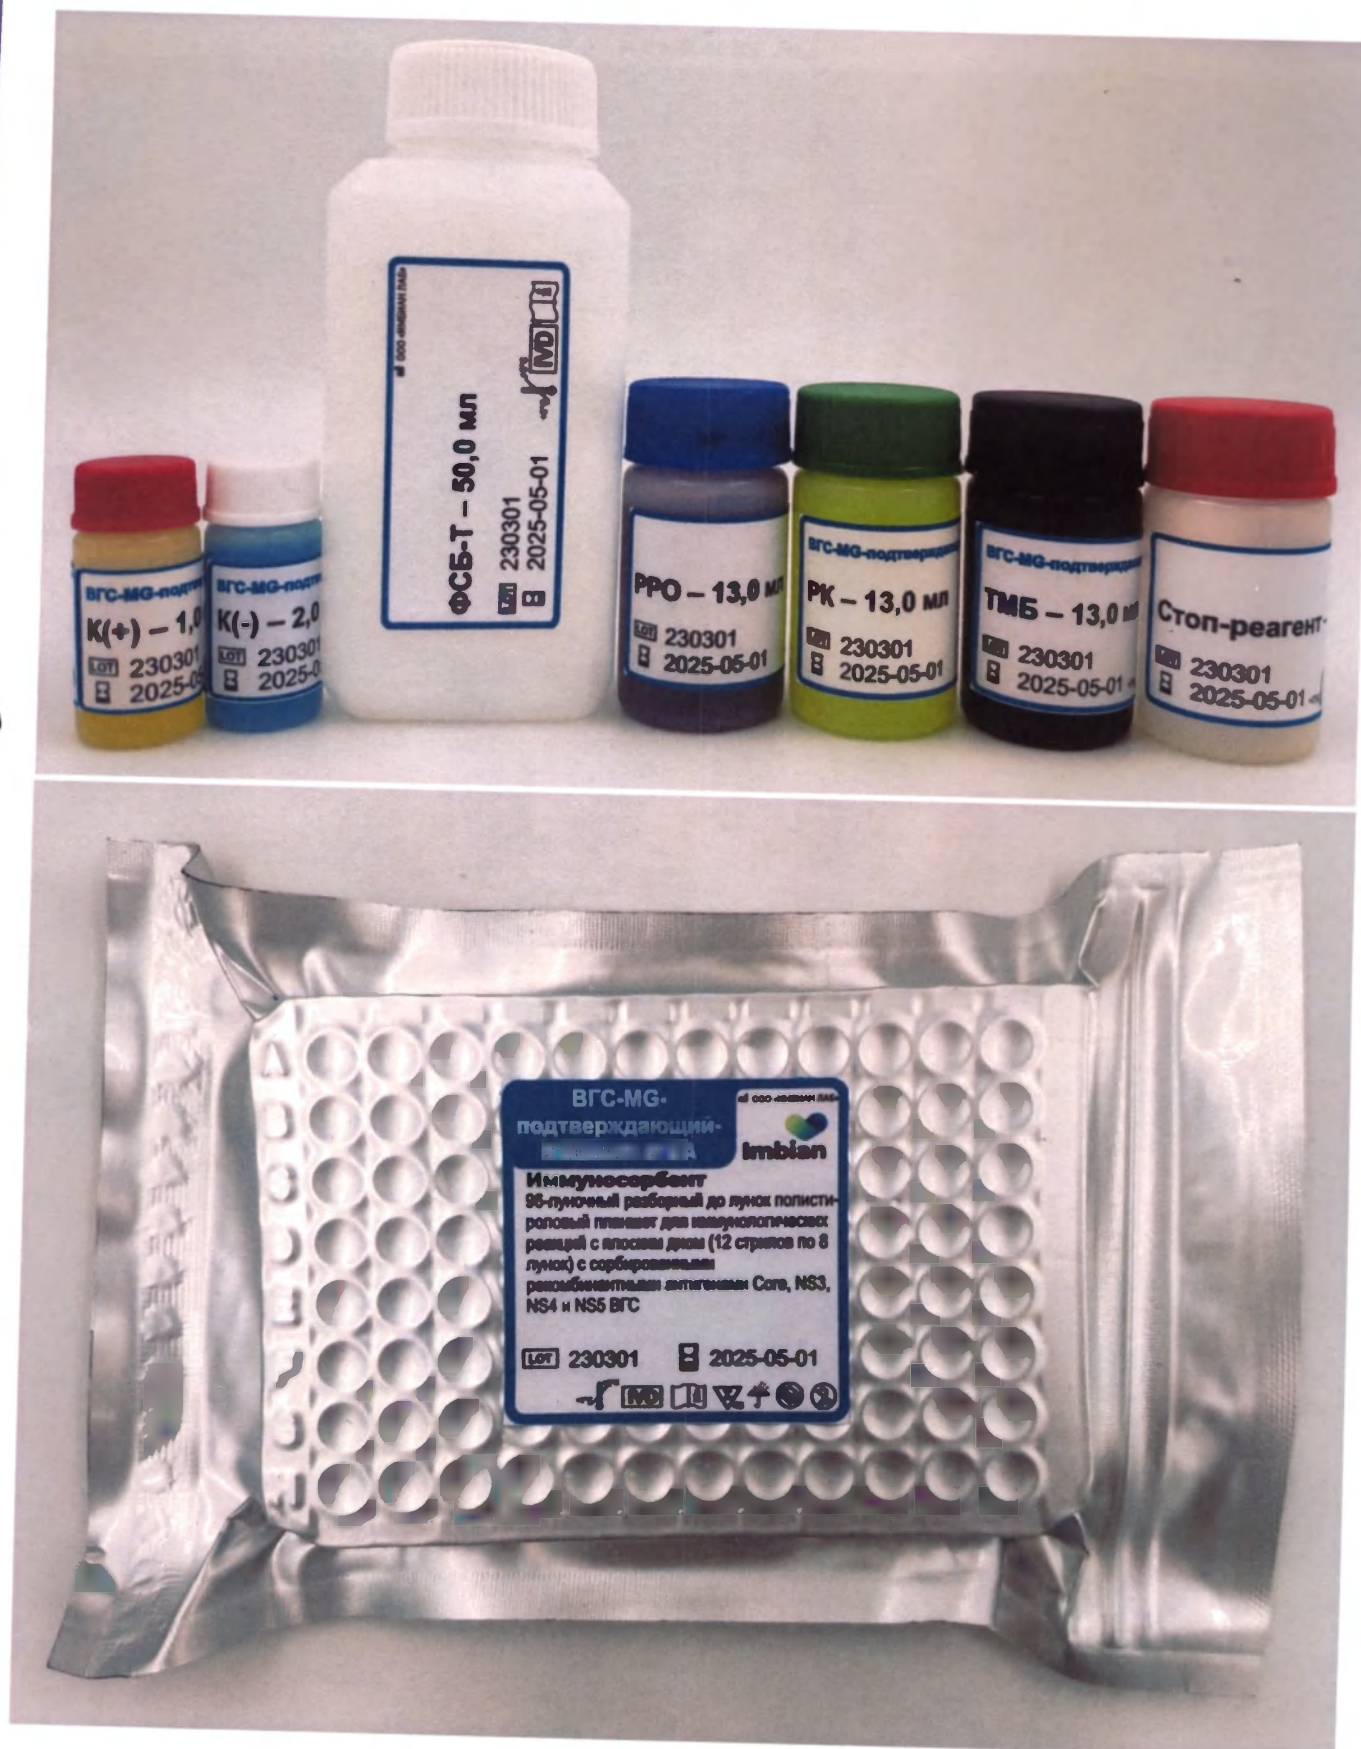
Замораживание не допускается.  
Для профессионального применения.  
Антитела к ВГС 1, 2 и HBeAg отсутствуют.



**IVD**



**ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,  
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,  
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2  
+7 (383) 209-34-54  
[www.imbian.ru](http://www.imbian.ru)  
[info@imbian.ru](mailto:info@imbian.ru)**



## Комплект №2



**ВГС-MG-**  
**подтверждающий-**  
**ИМБИАН-ИФА**  
Комплект №2

**Набор реагентов для качественного иммуноферментного подтверждения антител класса М и G к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме и препаратах крови «ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-463-41390295-2023**  
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

- 1 Иммуносорбент
- 2 К(+) - инaktivированный положительный контрольный образец, 2,0 мл
- 3 К(-) - отрицательный контрольный образец, 4,0 мл
- 4 ФСБ-Т - концентрат промывочного раствора, 100,0 мл
- 5 РРО - раствор для разведения образцов, 25,0 мл
- 6 РК - раствор конъюгата, 25,0 мл
- 7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина, 25,0 мл
- 8 Стоп-реагент, 25,0 мл
- 9 Пленка для заклеивания планшета
- 10 Ванночка
- 11 Наконечник
- 12 Инструкция по применению

1 шт.  
1 фл.  
1 фл.  
1 фл.  
1 фл.  
1 фл.  
1 фл.  
1 фл.  
1 фл.  
6 шт.  
48 шт.  
1 шт.

**ПУ №**

**LOT**

230302

**REF**

VE-014/96.2

**EXP**

2023-03-02


**EXP**

2025-05-02

**Imbian**



Замораживание не допускается.  
Для профессионального применения.  
Антитела к ВИЧ 1, 2 и HBsAg отсутствуют.



**ООО «ИМБИАН ЛАБ»**, 630559, Россия, Новосибирская область,  
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,  
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2  
+7 (383) 209-34-54  
[www.imbian.ru](http://www.imbian.ru)  
[info@imbian.ru](mailto:info@imbian.ru)



The image shows the BCS-MG-IMBIAN-IFA reagent kit components. The kit includes a large box with a list of contents, several bottles of reagents (PK, TMB, Stop-reagent, K(+), K(-)), a microtiter plate, and a manual. The box is labeled "BCS-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА" and "Комплект №3". The manual is titled "Инструкция по применению".

**ВГС-MG-  
подтверждающий-  
ИМБИАН-ИФА**  
Комплект №3

**Набор реагентов для качественного иммуноферментного подтверждения антител класса М и G к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме и препаратах крови «ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-463-41390295-2023**  
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

- 1 Иммуносорбент
- 2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец, 5,0 мл
- 3 К(-) - отрицательный контрольный образец, 10,0 мл
- 4 ФСБ-Т - концентрат промывочного раствора, 250,0 мл
- 5 РРО - раствор для разведения образцов, 61,0 мл
- 6 РК - раствор конъюгата, 61,0 мл
- 7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина, 61,0 мл
- 8 Стоп-реагент, 61,0 мл
- 9 Пленка для заклеивания планшета
- 10 Ванночка
- 11 Наконечник
- 12 Инструкция по применению

5 шт.  
1 фл.  
1 фл.  
1 фл.  
1 фл.  
1 фл.  
1 фл.  
15 шт.  
15 шт.  
120 шт.  
1 шт.

РУ №

**LOT** 230303

**REF** VE-014/240.3


**2023-03-03**

**2025-05-03**

**Imbian**



Замораживание не допускается.  
Для профессионального применения.  
Антитела к ВМН 1, 2 и ИВсAg отсутствуют.



**ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,  
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,  
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2  
+7 (383) 209-34-54  
[www.imbian.ru](http://www.imbian.ru)  
[info@imbian.ru](mailto:info@imbian.ru)**



## Комплект №4



**ВГС-MG-  
подтверждающий-  
ИМБИАН-ИФА**  
Комплект №4

**Набор реагентов для качественного иммуноферментного подтверждения антител класса М и G к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме и препаратах крови «ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-463-41390295-2023**

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

- |                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 Иммуносорбент                                                     | 5 шт. |
| 2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец, 5,0 мл | 1 фл. |
| 3 К(-) - отрицательный контрольный образец, 10,0 мл                 | 1 фл. |
| 4 ФСБ-Т - концентрат промывочного раствора, 250,0 мл                | 1 фл. |
| 5 РРО - раствор для разведения образцов, 100,0 мл                   | 1 фл. |
| 6 РК - раствор конъюгата, 80,0 мл                                   | 1 фл. |
| 7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина, 80,0 мл                        | 1 фл. |
| 8 Стоп-реагент, 250,0 мл                                            | 1 фл. |
| 9 Инструкция по применению                                          | 1 шт. |


РУ №

LOT 230304  
REF VE-014/240.4  
2023-03-04  
2025-05-04

**Imbian**



Замораживание не допускается.  
Для профессионального применения.  
Антитела к ВИЧ 1, 2 и HBsAg отсутствуют.



**ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,  
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,  
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2  
+7 (383) 209-34-54  
[www.imbian.ru](http://www.imbian.ru)  
[info@imbian.ru](mailto:info@imbian.ru)**



Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью

лист 13  
Генеральный директор  
ООО «ИМБИАН ЛАБ»  
В.В. Осипова  
" 24 " 2023 г



**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

/В.В. Осипова/

20 13 г.

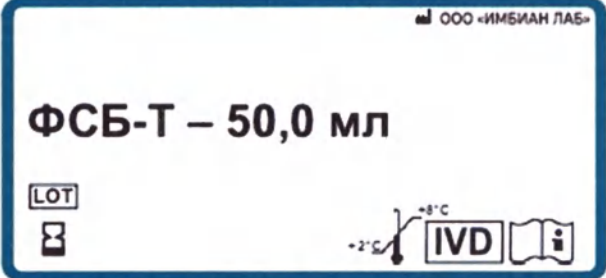
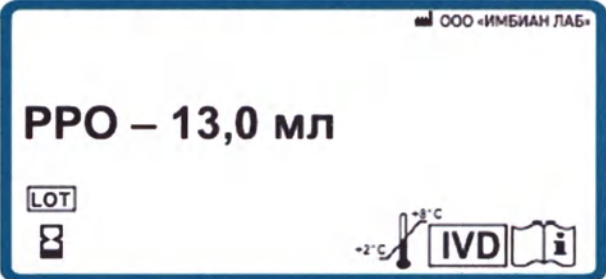


**Проект маркировки**

**Набор реагентов для качественного иммуноферментного подтверждения антител класса  
М и G к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме и препаратах крови  
«ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА»  
по ТУ 21.20.23-463-41390295-2023**

1. Образцы маркировки Набора реагентов «ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА» комплекта №1

1.1. Образцы маркировки внутренней упаковки

| Наименование компонента                                   | Маркировка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иммуносорбент                                             |  <p><b>ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА</b></p> <p>ООО «ИМБИАН ЛАБ»</p> <p><b>Imbian</b></p> <p><b>Иммуносорбент</b><br/>96-луночный разборный до лунок полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированными рекомбинантными антигенами Core, NS3, NS4 и NS5 ВГС</p> <p>LOT</p> <p>Icons: -2°C, IVD, information, 48, biohazard, and a crossed-out symbol.</p> |
| К(+) – инактивированный положительный контрольный образец |  <p><b>ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА</b></p> <p>ООО «ИМБИАН ЛАБ»</p> <p><b>К(+) – 1,0 мл (Инактивирован)</b></p> <p>LOT</p> <p>Icons: -2°C, +8°C, IVD, information, and biohazard.</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| К(-) – отрицательный контрольный образец                  |  <p><b>ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА</b></p> <p>ООО «ИМБИАН ЛАБ»</p> <p><b>К(-) – 2,0 мл</b></p> <p>LOT</p> <p>Icons: -2°C, +8°C, IVD, and information.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ФСБ-Т – концентрат промывочного раствора                  |  <p>ООО «ИМБИАН ЛАБ»</p> <p><b>ФСБ-Т – 50,0 мл</b></p> <p>LOT</p> <p>Icons: -2°C, +8°C, IVD, and information.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| РРО – раствор для разведения образцов                     |  <p>ООО «ИМБИАН ЛАБ»</p> <p><b>РРО – 13,0 мл</b></p> <p>LOT</p> <p>Icons: -2°C, +8°C, IVD, and information.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |





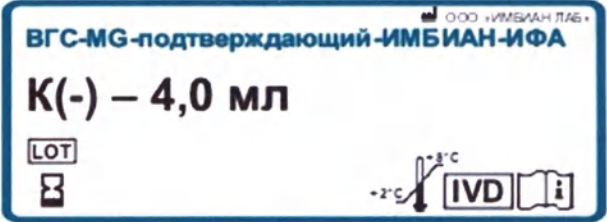
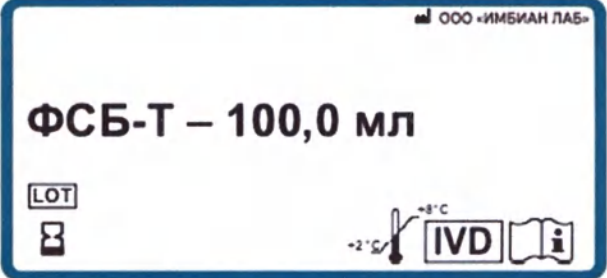
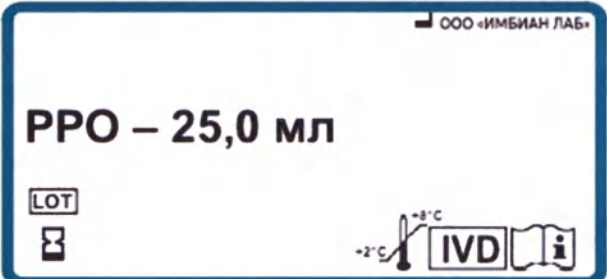
ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,  
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,  
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2  
+7 (383) 209-34-54

[www.imbian.ru](http://www.imbian.ru)

[info@imbian.ru](mailto:info@imbian.ru)

2. Образцы маркировки Набора реагентов «ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА» комплекта №2

2.1. Образцы маркировки внутренней упаковки

| Наименование компонента                                   | Маркировка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иммуносорбент                                             |  <p><b>ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА</b></p> <p><b>Иммуносорбент</b></p> <p>96-луночный разборный до лунок полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированными рекомбинантными антигенами Core, NS3, NS4 и NS5 ВГС</p> <p>LOT</p> <p>+2°C</p> <p>IVD</p> |
| К(+) – инактивированный положительный контрольный образец |  <p><b>ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА</b></p> <p><b>К(+) – 2,0 мл (Инактивирован)</b></p> <p>LOT</p> <p>+2°C</p> <p>IVD</p>                                                                                                                                                                                      |
| К(-) – отрицательный контрольный образец                  |  <p><b>ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА</b></p> <p><b>К(-) – 4,0 мл</b></p> <p>LOT</p> <p>+2°C</p> <p>IVD</p>                                                                                                                                                                                                     |
| ФСБ-Т – концентрат промывочного раствора                  |  <p><b>ФСБ-Т – 100,0 мл</b></p> <p>LOT</p> <p>+2°C</p> <p>IVD</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| РРО – раствор для разведения образцов                     |  <p><b>РРО – 25,0 мл</b></p> <p>LOT</p> <p>+2°C</p> <p>IVD</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РК – раствор конъюгата            | <div> <div>ООО «ИМБИАН ЛАБ»</div> <div><b>ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА</b></div> <div><b>РК – 25,0 мл</b></div> <div> <div>LOT</div> <div></div> <div> <div>+8°C</div> <div>+2°C</div> <div>IVD</div> <div></div> </div> </div> </div>              |
| ТМБ – раствор тетраметилбензидина | <div> <div>ООО «ИМБИАН ЛАБ»</div> <div><b>ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА</b></div> <div><b>ТМБ – 25,0 мл</b></div> <div> <div>LOT</div> <div></div> <div> <div>+8°C</div> <div>+2°C</div> <div>IVD</div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div> |
| Стоп-реагент                      | <div> <div>ООО «ИМБИАН ЛАБ»</div> <div><b>Стоп-реагент – 25,0 мл</b></div> <div> <div>LOT</div> <div></div> <div> <div>+8°C</div> <div>+2°C</div> <div>IVD</div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div>                                           |

## 2.2. Образцы маркировки потребительской упаковки

**ВГС-MG-  
подтверждающий-  
ИМБИАН-ИФА**

**Комплект №2**

**Набор реагентов для качественного иммуноферментного подтверждения антител класса М и G к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме и препаратах крови «ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-463-41390295-2023**  
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

|                                                                     |        |             |            |            |             |  |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|------------|-------------|--|
| 1 Иммуносорбент                                                     | 1 шт.  | <b>ПУ №</b> | <b>LOT</b> | <b>REF</b> | VE-014/96.2 |  |
| 2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец, 2,0 мл | 1 фл.  |             |            |            |             |  |
| 3 К(-) - отрицательный контрольный образец, 4,0 мл                  | 1 фл.  |             |            |            |             |  |
| 4 ФСБ-Т - концентрат промывочного раствора, 100,0 мл                | 1 фл.  |             |            |            |             |  |
| 5 РРО - раствор для разведения образцов, 25,0 мл                    | 1 фл.  |             |            |            |             |  |
| 6 РК - раствор конъюгата, 25,0 мл                                   | 1 фл.  |             |            |            |             |  |
| 7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина, 25,0 мл                        | 1 фл.  |             |            |            |             |  |
| 8 Стоп-реагент, 25,0 мл                                             | 1 фл.  |             |            |            |             |  |
| 9 Пленка для заклеивания планшета                                   | 6 шт.  |             |            |            |             |  |
| 10 Ванночка                                                         | 6 шт.  |             |            |            |             |  |
| 11 Наконечник                                                       | 48 шт. |             |            |            |             |  |
| 12 Инструкция по применению                                         | 1 шт.  |             |            |            |             |  |

Замораживание не допускается.  
Для профессионального применения.  
Антитела к ВИЧ 1, 2 и HbSAg отсутствуют.

+8°C

+2°C

IVD

96



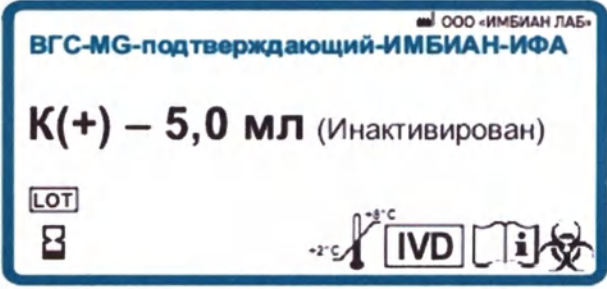
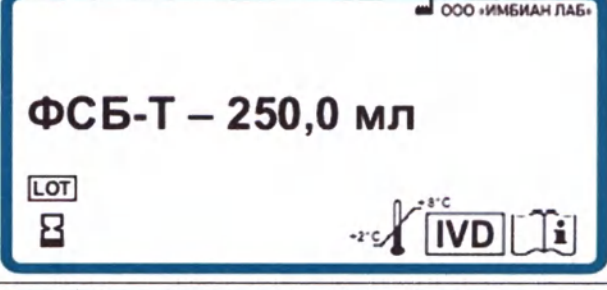
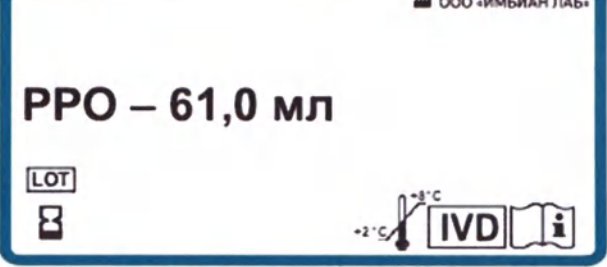
ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,  
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,  
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2  
+7 (383) 209-34-54

[www.imbian.ru](http://www.imbian.ru)

[info@imbian.ru](mailto:info@imbian.ru)

### 3. Образцы маркировки Набора реагентов «ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА» комплекта №3

#### 3.1. Образцы маркировки внутренней упаковки

| Наименование компонента                                   | Маркировка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иммуносорбент                                             |  <p><b>ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА</b></p> <p><b>Иммуносорбент</b><br/>96-луночный разборный до лунок полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок) с сорбированными рекомбинантными антигенами Core, NS3, NS4 и NS5 ВГС</p> <p>LOT</p> <p>Icons: -2°C, 8°C, IVD, information, 48, biohazard, no open flame, no eating/drinking</p> |
| К(+) – инактивированный положительный контрольный образец |  <p><b>ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА</b></p> <p><b>К(+) – 5,0 мл (Инактивирован)</b></p> <p>LOT</p> <p>Icons: -2°C, 8°C, IVD, information, biohazard</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| К(-) – отрицательный контрольный образец                  |  <p><b>ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА</b></p> <p><b>К(-) – 10,0 мл</b></p> <p>LOT</p> <p>Icons: -2°C, 8°C, IVD, information</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ФСБ-Т – концентрат промывочного раствора                  |  <p><b>ФСБ-Т – 250,0 мл</b></p> <p>LOT</p> <p>Icons: -2°C, 8°C, IVD, information</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| РРО – раствор для разведения образцов                     |  <p><b>РРО – 61,0 мл</b></p> <p>LOT</p> <p>Icons: -2°C, 8°C, IVD, information</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РК – раствор конъюгата            | <div> <div>ООО «ИМБИАН ЛАБ»</div> <div><b>ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА</b></div> <div><b>РК – 61,0 мл</b></div> <div> <div>LOT</div> <div></div> <div> <div>+2°C</div> <div>+8°C</div> <div>IVD</div> <div></div> </div> </div> </div>              |
| ТМБ – раствор тетраметилбензидина | <div> <div>ООО «ИМБИАН ЛАБ»</div> <div><b>ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА</b></div> <div><b>ТМБ – 61,0 мл</b></div> <div> <div>LOT</div> <div></div> <div> <div>+2°C</div> <div>+8°C</div> <div>IVD</div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div> |
| Стоп-реагент                      | <div> <div>ООО «ИМБИАН ЛАБ»</div> <div><b>Стоп-реагент – 61,0 мл</b></div> <div> <div>LOT</div> <div></div> <div> <div>+2°C</div> <div>+8°C</div> <div>IVD</div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div>                                           |

### 3.2. Образцы маркировки потребительской упаковки

**ВГС-MG-  
подтверждающий-  
ИМБИАН-ИФА**

**Комплект №3**

**Набор реагентов для качественного иммуноферментного подтверждения антител класса М и G к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме и препаратах крови «ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-463-41390295-2023**  
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

1 Иммуносорбент

2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец, 5,0 мл

3 К(-) - отрицательный контрольный образец, 10,0 мл

4 ФСБ-Т - концентрат промывочного раствора, 250,0 мл

5 РРО - раствор для разведения образцов, 61,0 мл

6 РК - раствор конъюгата, 61,0 мл

7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина, 61,0 мл

8 Стоп-реагент, 61,0 мл

9 Пленка для заклеивания планшета

10 Ванночка

11 Наконечник

12 Инструкция по применению

5 шт.

1 фл.

1 фл.

1 фл.

1 фл.

1 фл.

1 фл.

1 фл.

15 шт.

15 шт.

120 шт.

1 шт.

РУ №

LOT

REF VE-014/240.3

4 620102 805080

Замораживание не допускается.

Для профессионального применения.

Антитела к ВИЧ 1, 2 и HBsAg отсутствуют.

+2°C

+8°C

IVD

240

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9



ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,  
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,  
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2  
+7 (383) 209-34-54  
[www.imbian.ru](http://www.imbian.ru)  
[info@imbian.ru](mailto:info@imbian.ru)

4. Образцы маркировки Набора реагентов «ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА» комплекта №4

4.1. Образцы маркировки внутренней упаковки

| Наименование компонента                                   | Маркировка |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Иммуносорбент                                             |            |
| К(+) – инактивированный положительный контрольный образец |            |
| К(-) – отрицательный контрольный образец                  |            |
| ФСБ-Т – концентрат промывочного раствора                  |            |
| РРО – раствор для разведения образцов                     |            |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| РК – раствор конъюгата            | <div> <div>ООО «ИМБИАН ЛАБ»</div> <div><b>ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА</b></div> <div><b>РК – 80,0 мл</b></div> <div> <div>LOT</div> <div></div> <div> <div>+8°C</div> <div>+2°C</div> <div></div> <div><b>IVD</b></div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div>              |
| ТМБ – раствор тетраметилбензидина | <div> <div>ООО «ИМБИАН ЛАБ»</div> <div><b>ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА</b></div> <div><b>ТМБ – 80,0 мл</b></div> <div> <div>LOT</div> <div></div> <div> <div>+8°C</div> <div>-2°C</div> <div></div> <div><b>IVD</b></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div> |
| Стоп-реагент                      | <div> <div>ООО «ИМБИАН ЛАБ»</div> <div><b>Стоп-реагент – 250,0 мл</b></div> <div> <div>LOT</div> <div></div> <div> <div>+8°C</div> <div>-2°C</div> <div></div> <div><b>IVD</b></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div>                                          |

#### 4.2. Образцы маркировки потребительской упаковки

**ВГС-MG-  
подтверждающий-  
ИМБИАН-ИФА**

**Комплект №4**

**Набор реагентов для качественного иммуноферментного подтверждения антител класса М и G к вирусу гепатита С в сыворотке, плазме и препаратах крови «ВГС-MG-подтверждающий-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-463-41390295-2023**  
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

1 Иммуносорбент

2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец, 5,0 мл

3 К(-) - отрицательный контрольный образец, 10,0 мл

4 ФСБ-Т - концентрат промывочного раствора, 250,0 мл

5 РРО - раствор для разведения образцов, 100,0 мл

6 РК - раствор конъюгата, 80,0 мл

7 ТМБ - раствор тетраметилбензидина, 80,0 мл

8 Стоп-реагент, 250,0 мл

9 Инструкция по применению

5 шт.

1 фл.

1 фл.

1 фл.

1 фл.

1 фл.

1 фл.

1 фл.

1 шт.

РУ №

LOT

REF

VE-014/240.4

Замораживание не допускается.

Для профессионального применения.

Антитела к ВИЧ 1, 2 и HBsAg отсутствуют.

+8°C

+2°C

**IVD**

240

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12



ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,  
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,  
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2  
+7 (383) 209-34-54  
[www.imbian.ru](http://www.imbian.ru)  
[info@imbian.ru](mailto:info@imbian.ru)



Пронумеровано, пронумеровано  
и скреплено печатью  
лист 06

Генеральный директор  
ООО «СИБИАН ЛАБ»  
В.В. Осипова  
"12" 06 2023 г