



REGICOM
est. 2008



REGICOM in Kazakhstan
Address: Almaty, 050000, st. Abylai Khan
122, office 12/13

Phone: +7 (727) 267-31-20
Mobile: +7 701-786-82-79 (WhatsApp)
Mobile: +7 701-789-90-00
E-mail: i.kozlov@regicompany.com

REGICOM in Russia
Address: Moscow, Shmitovskiy proezd, house 39,
building 2, apartment 10

Phone: +7 495 609-41-15
Mobile: +7 969-197-44-33
Mobile: +7 701-786-82-79 (WhatsApp)
E-mail: i.kozlov@regicompany.com

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «РЕГИКОМ»

И. Козлов Козлов И.
«01» ноября 2023 г.

Фотографические изображения

«Пила стернотомная хирургическая аккумуляторная GDP II с принадлежностями»

Производитель: SUZHOU AND SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP.
(СУЧЖОУ ЭНД САЙЕНС & ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.),
No. 2 Ansheng Road, Jinfeng Town, 215625 Zhangjiagang City, Jiangsu Province, P.R.China (Китай)

Пила стернотомная хирургическая аккумуляторная GDP II



Пила стернотомная хирургическая аккумуляторная GDP II – в упаковке






Зарядное устройство на два гнезда для оборудования хирургического для обработки костной ткани GDP




Переходник для пинцетов

Шнур питания для зарядного устройства

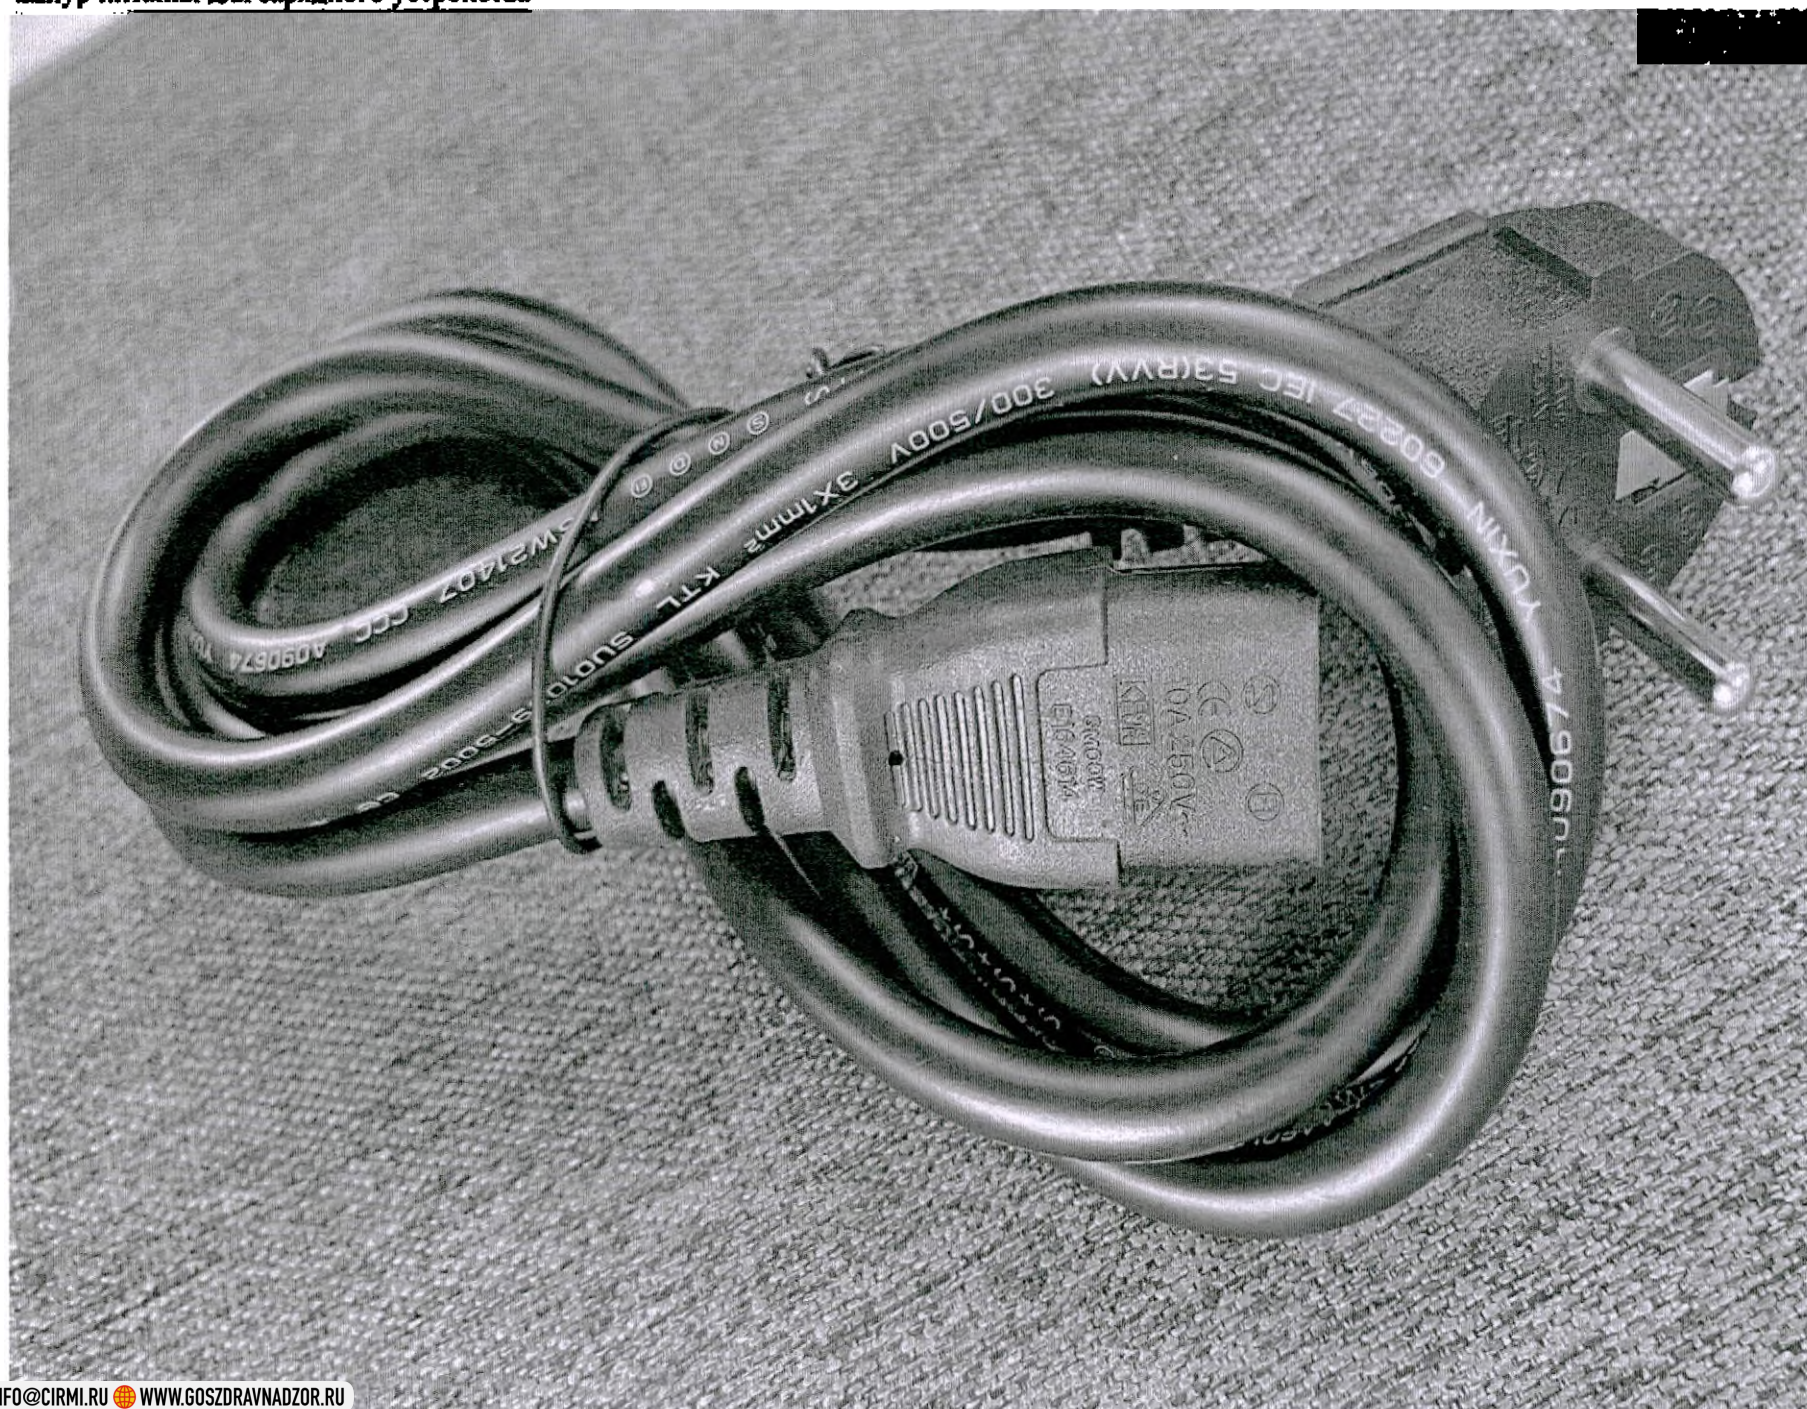





Батарея аккумуляторная большая (2200 мАч) для оборудования хирургического для обработки костной ткани GDP

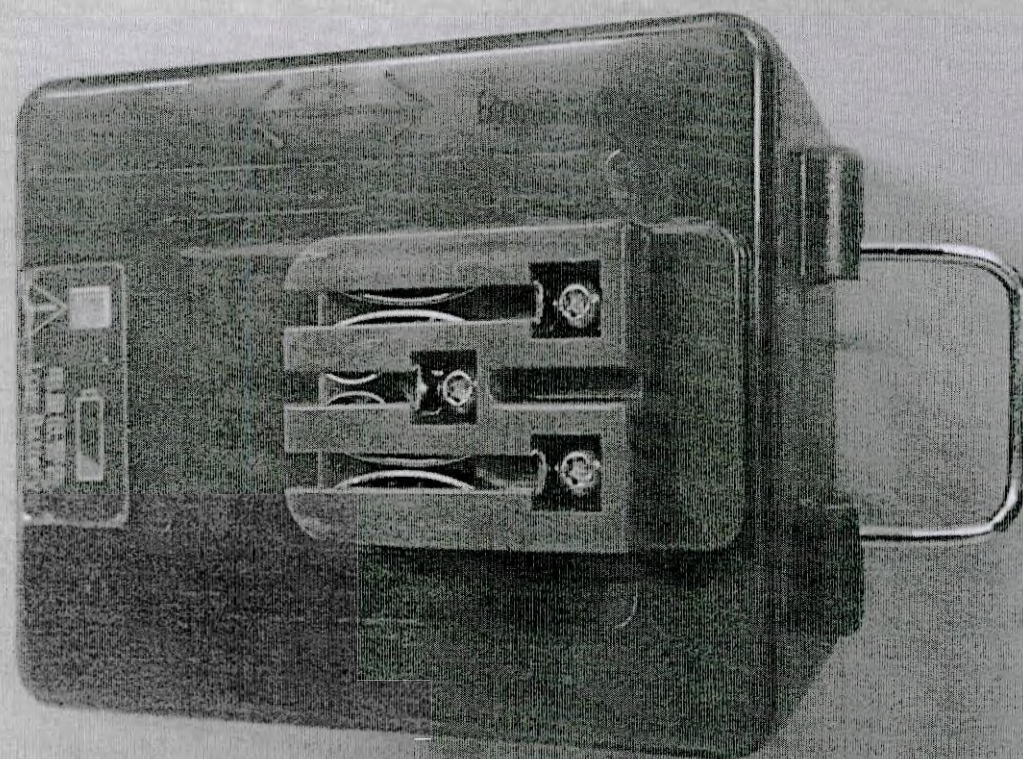

Батарея аккумуляторная большая (2200 мАч) для оборудования хирургического для обработки костной ткани GDP

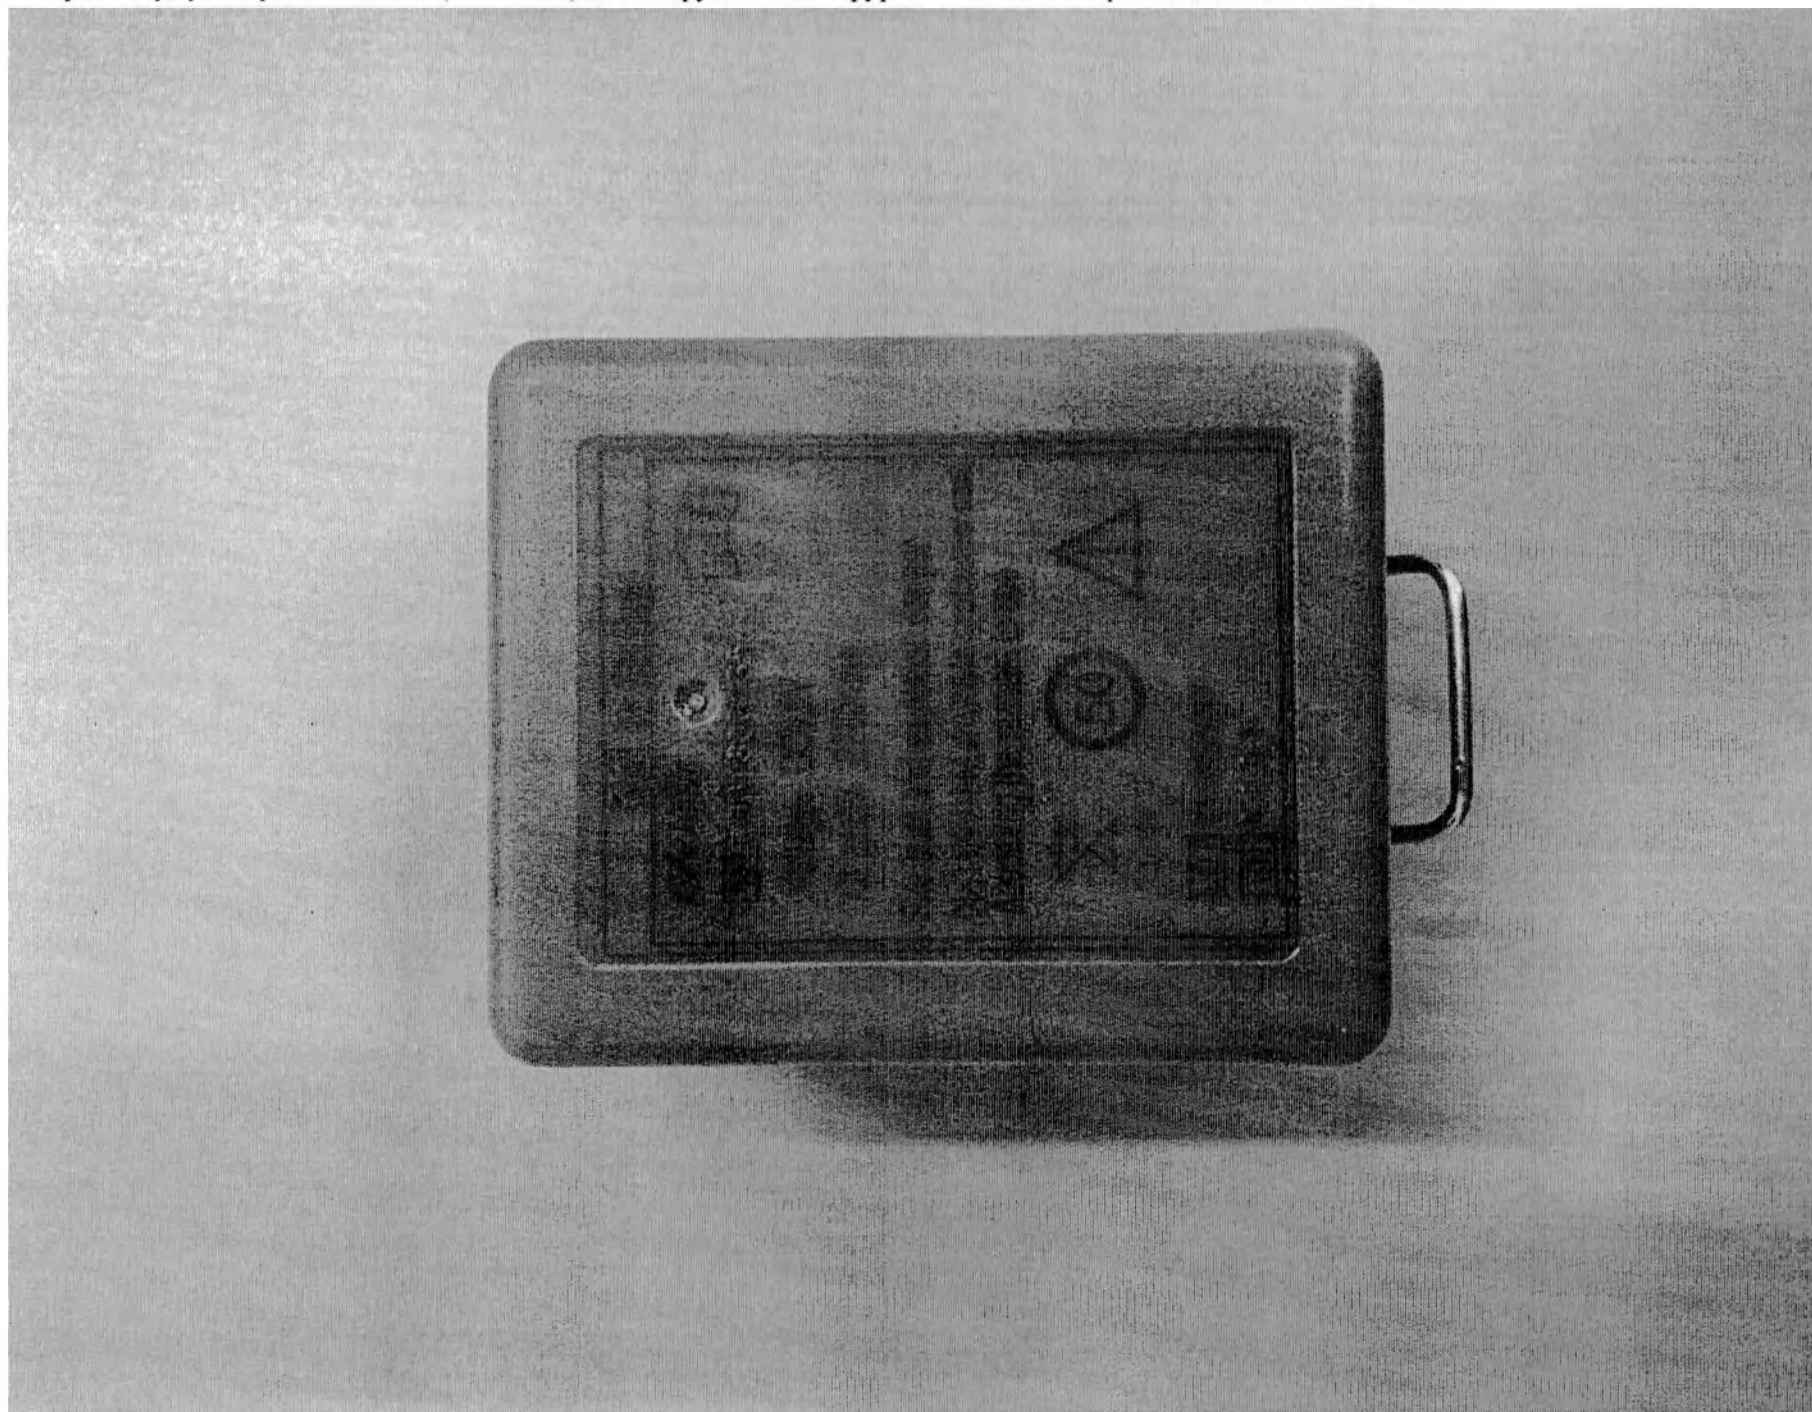


Батарея аккумуляторная малая (1100 мАч) для оборудования хирургического для обработки костной ткани GDP

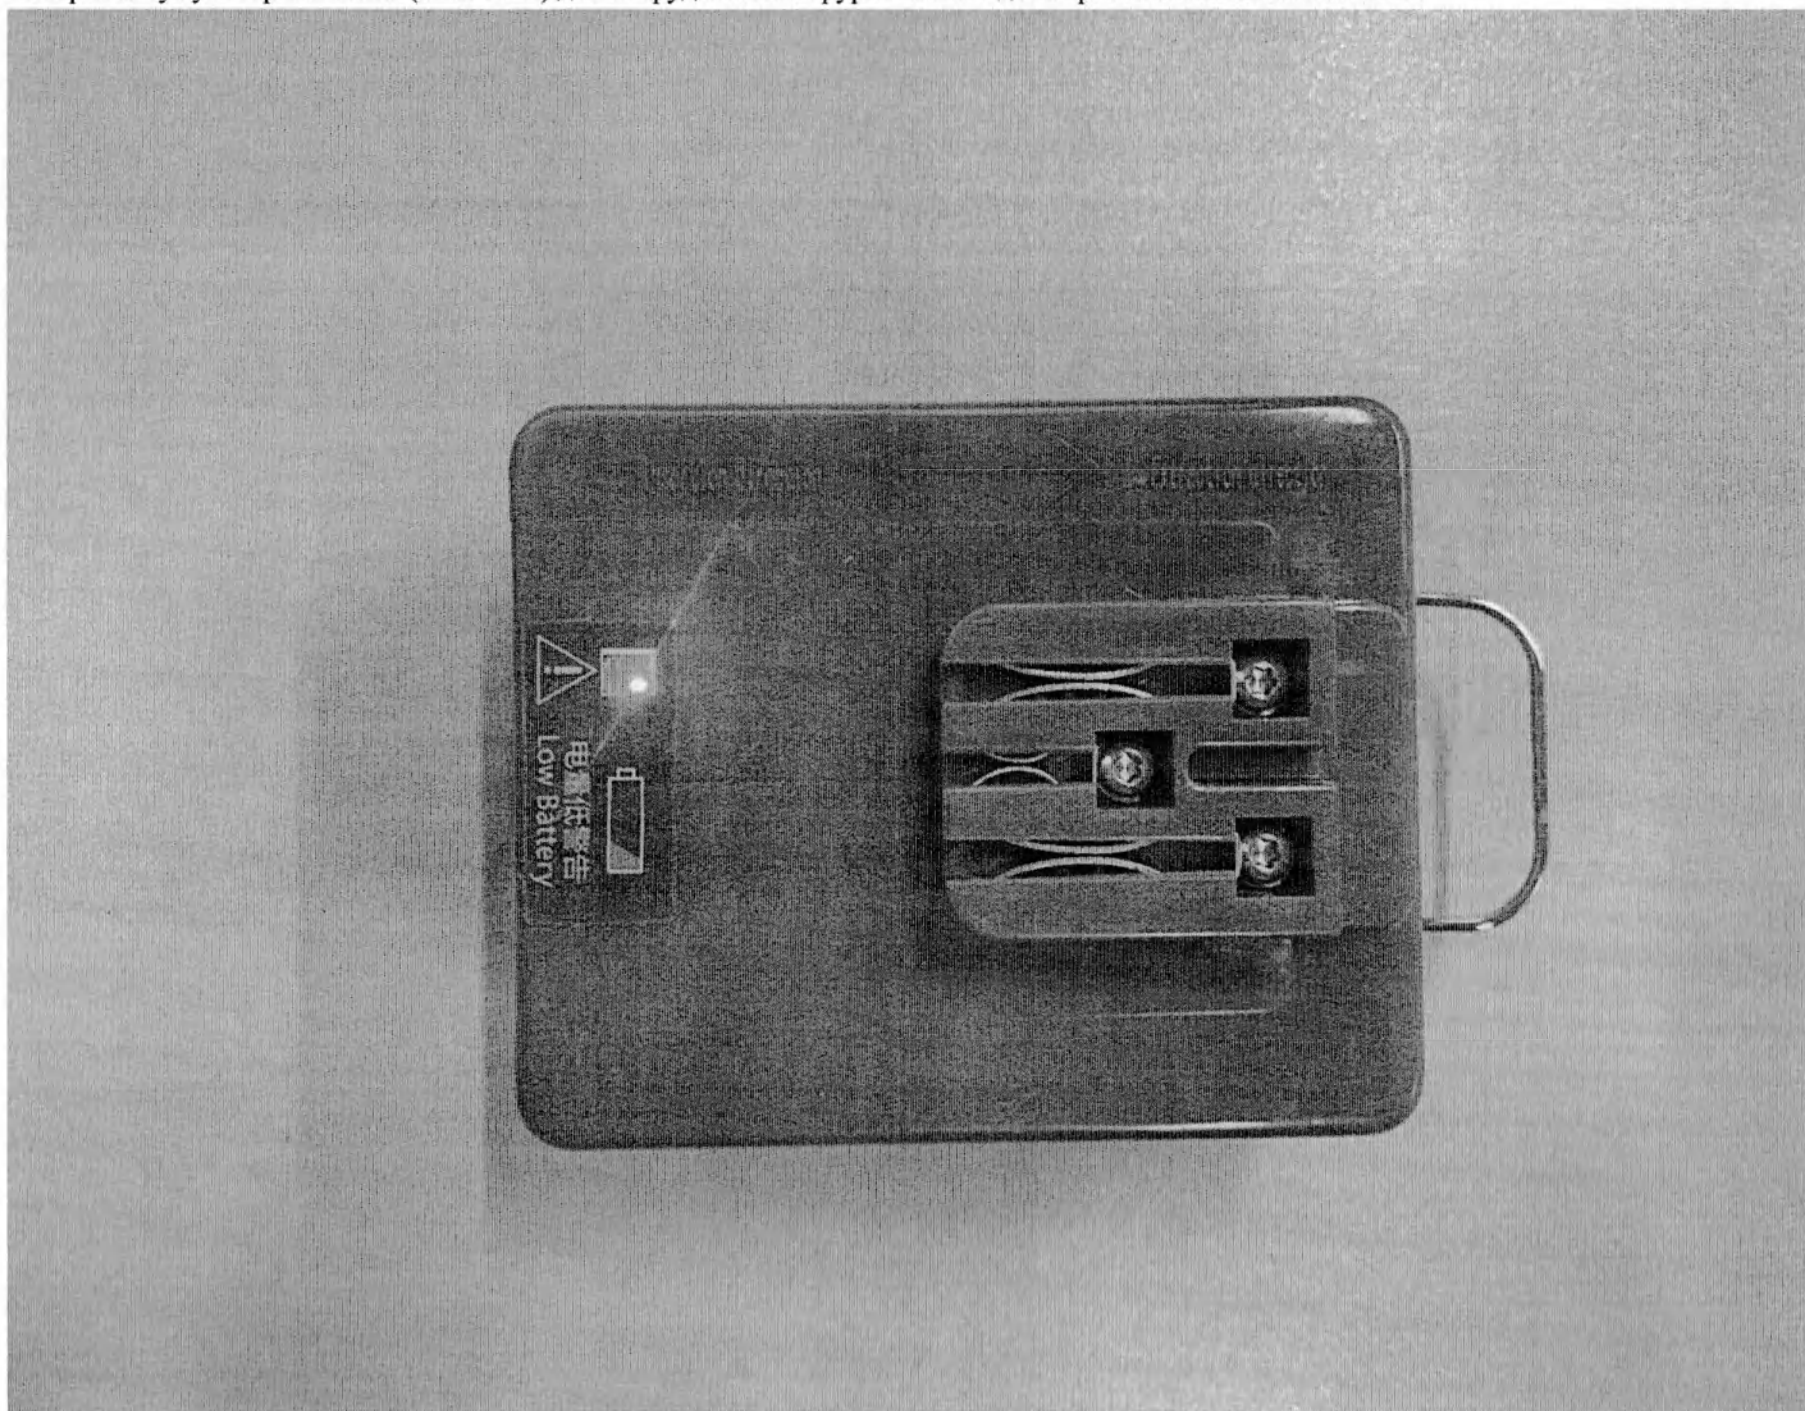


Батарея аккумуляторная малая (1100 мАч) для оборудования хирургического для обработки костной ткани GDP




Лезвие для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II размером: 6 x 0,6 x 40 мм

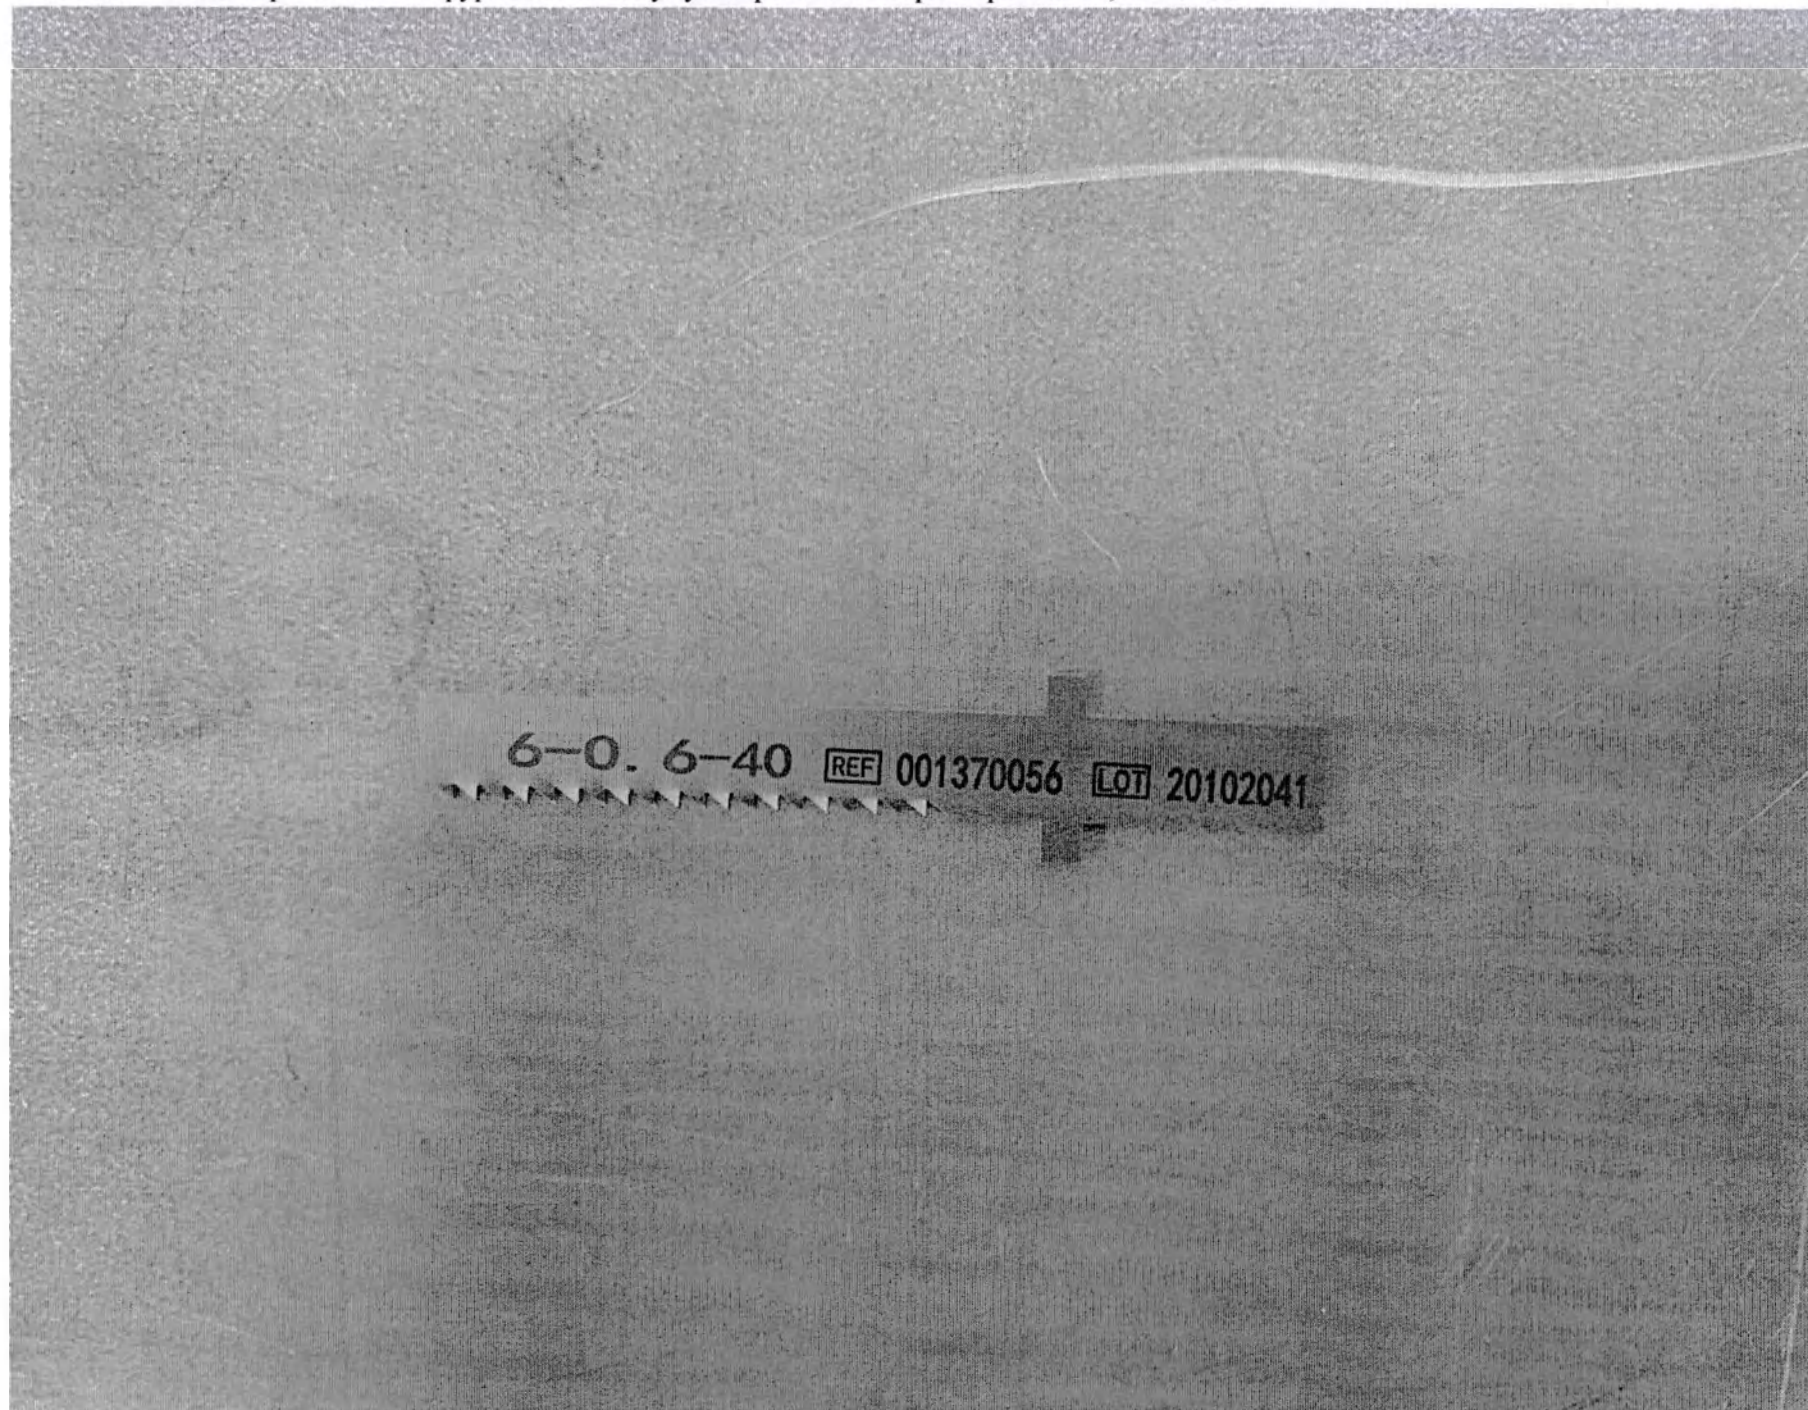


Чехол для батареи большой для оборудования хирургического для обработки костной ткани

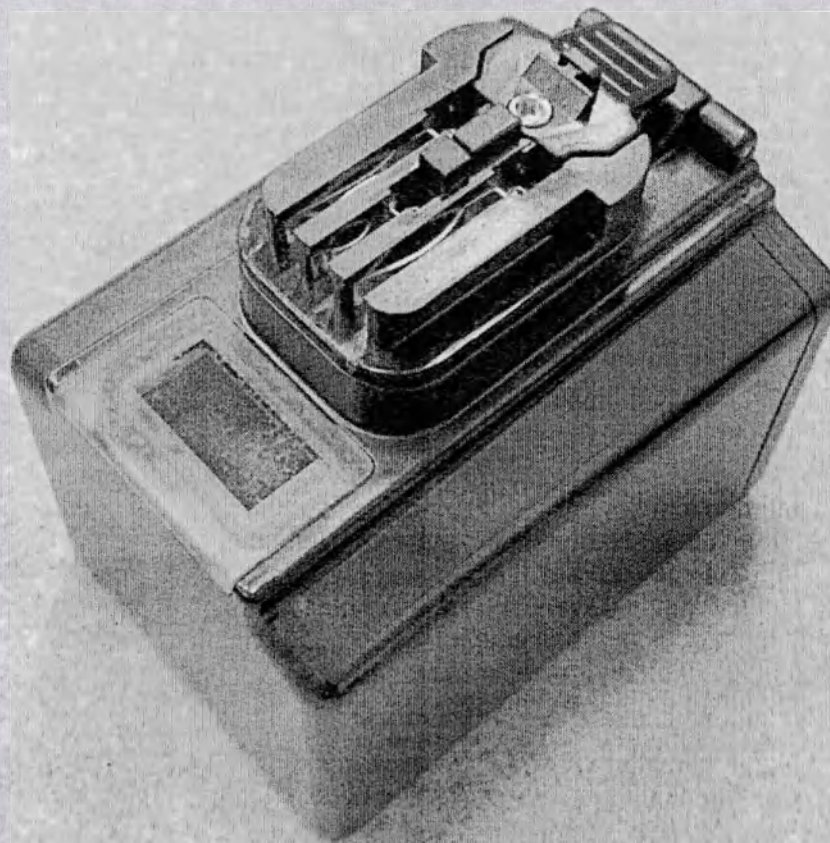


Чехол для батареи малый для оборудования хирургического для обработки костной ткани

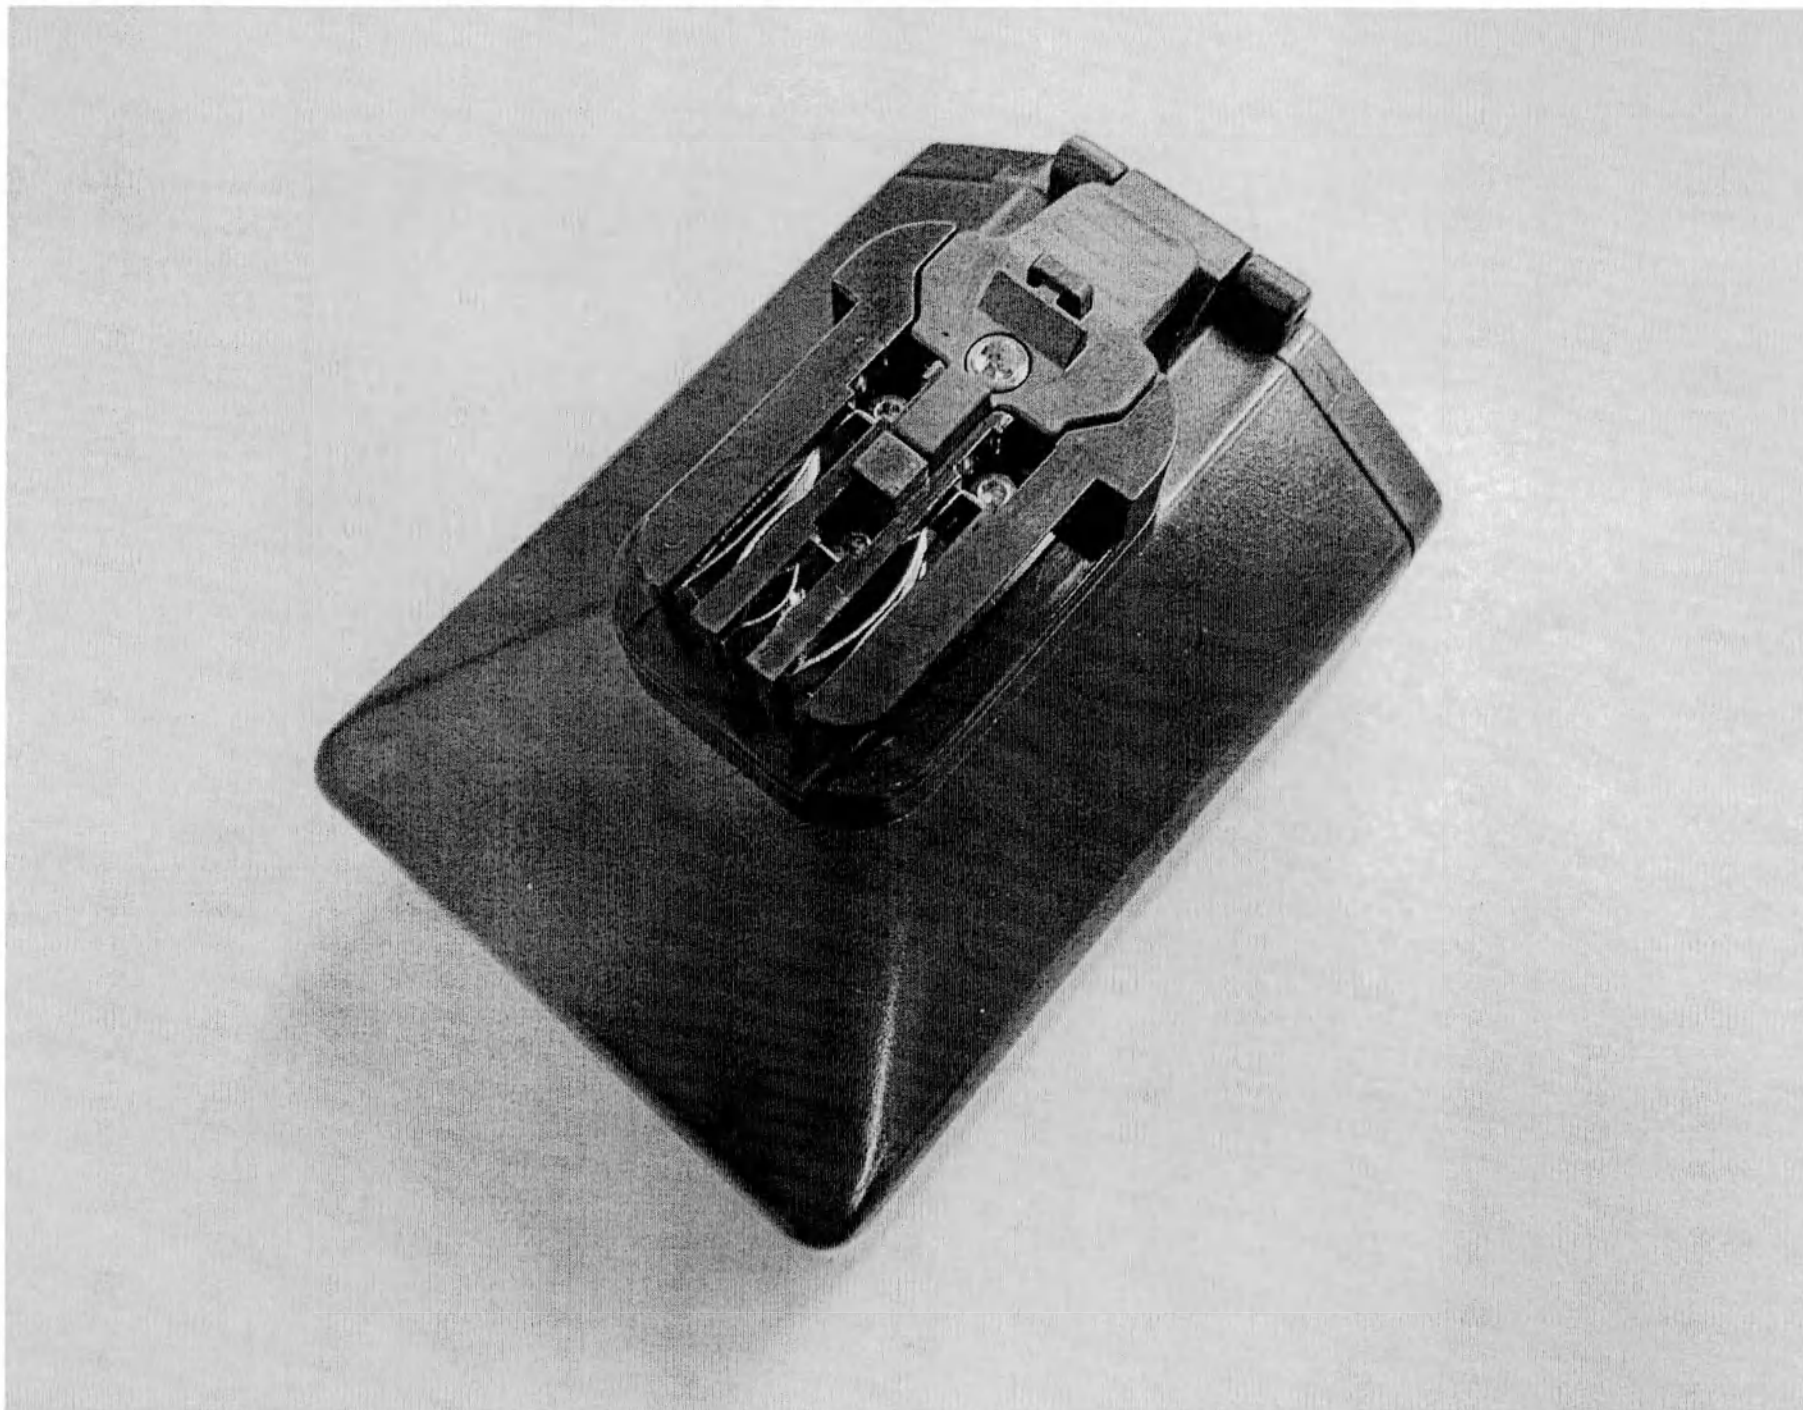

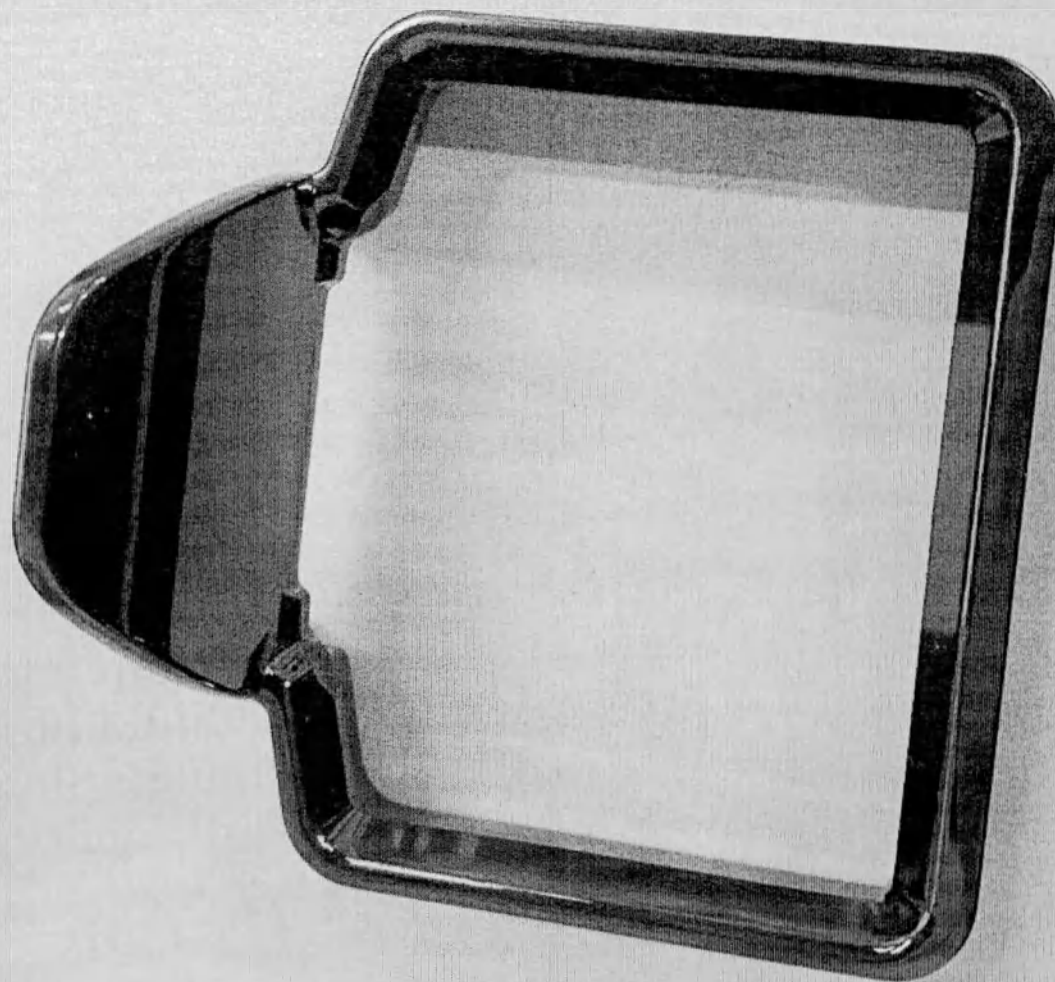


Канал стерилизационный малый для оборудования хирургического для обработки костной ткани GDP

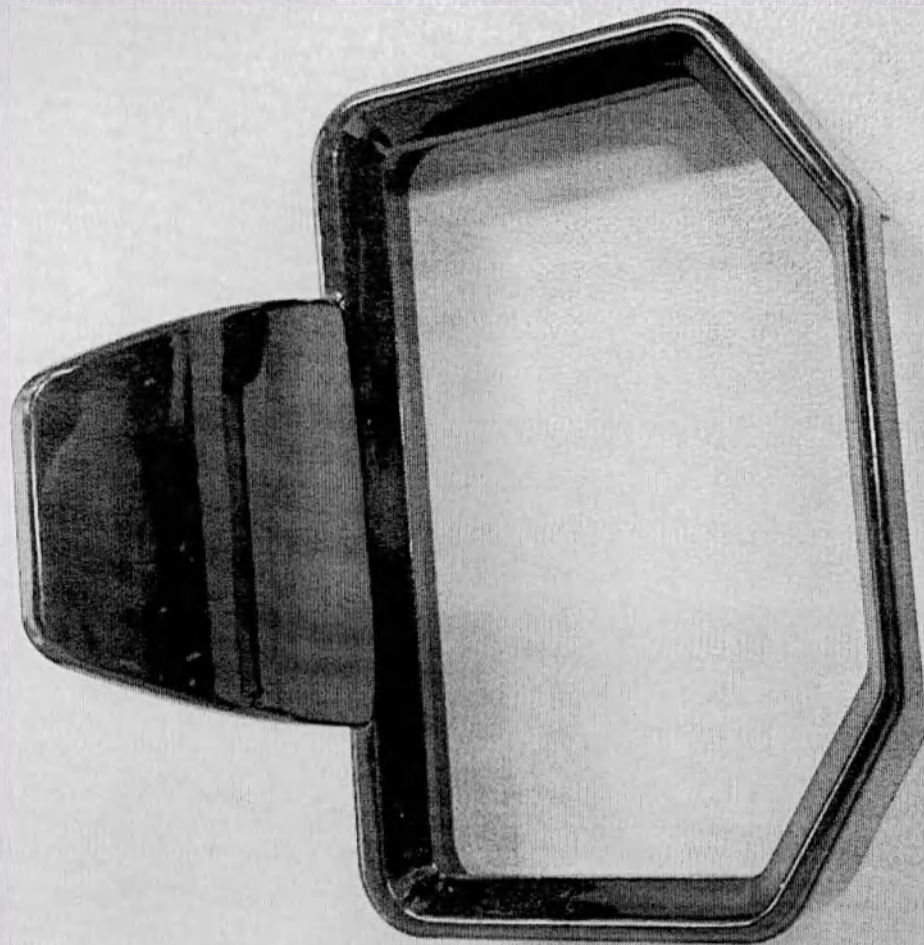




Product Code: 001331929
Product Name: Repair Module for
Surgical Reciprocating Sternum Saw
Product Model: GDP-II



21-08-02



21088889

Inspector Code: 38

Inspect Date: 2021.08



(11)210802(10)21088889(21)0003

SUZHOU AND SCIENCE & TECHNOLOGY
DEVELOPMENT CORP.

NO. 2 ANSHENG ROAD, JINFENG TOWN, 215625
ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R. CHINA

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Elbstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel.: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

MADE IN CHINA



Наименование медицинского изделия: Ремонтный модуль для пилы хирургических аккумуляторных GDP II
Код продукта: 001331929

Наименование производителя: SUZHOU AND SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP. (СУЧЖОУ ЭНДСАЙЕНС & ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.)

Местонахождение (юридический адрес) производителя: No. 2, ANSHENG ROAD, JINFENG TOWN, 215625 ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R. CHINA

(No. 2, ANSHENG ROAD, JINFENG TOWN, 215625 ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R. CHINA)

Страна происхождения медицинского изделия: Китай

Наименование производственной площадки: SUZHOU AND SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP. (СУЧЖОУ ЭНДСАЙЕНС & ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.)


Местонахождение (юридический адрес) производственной площадки: No. 2, ANSHENG ROAD, JINFENG TOWN, 215625 ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R. CHINA


(No. 2, ANSHENG ROAD, JINFENG TOWN, 215625 ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R. CHINA)


Код партии: 21088889

Год выпуска: 2021


Стерильно!

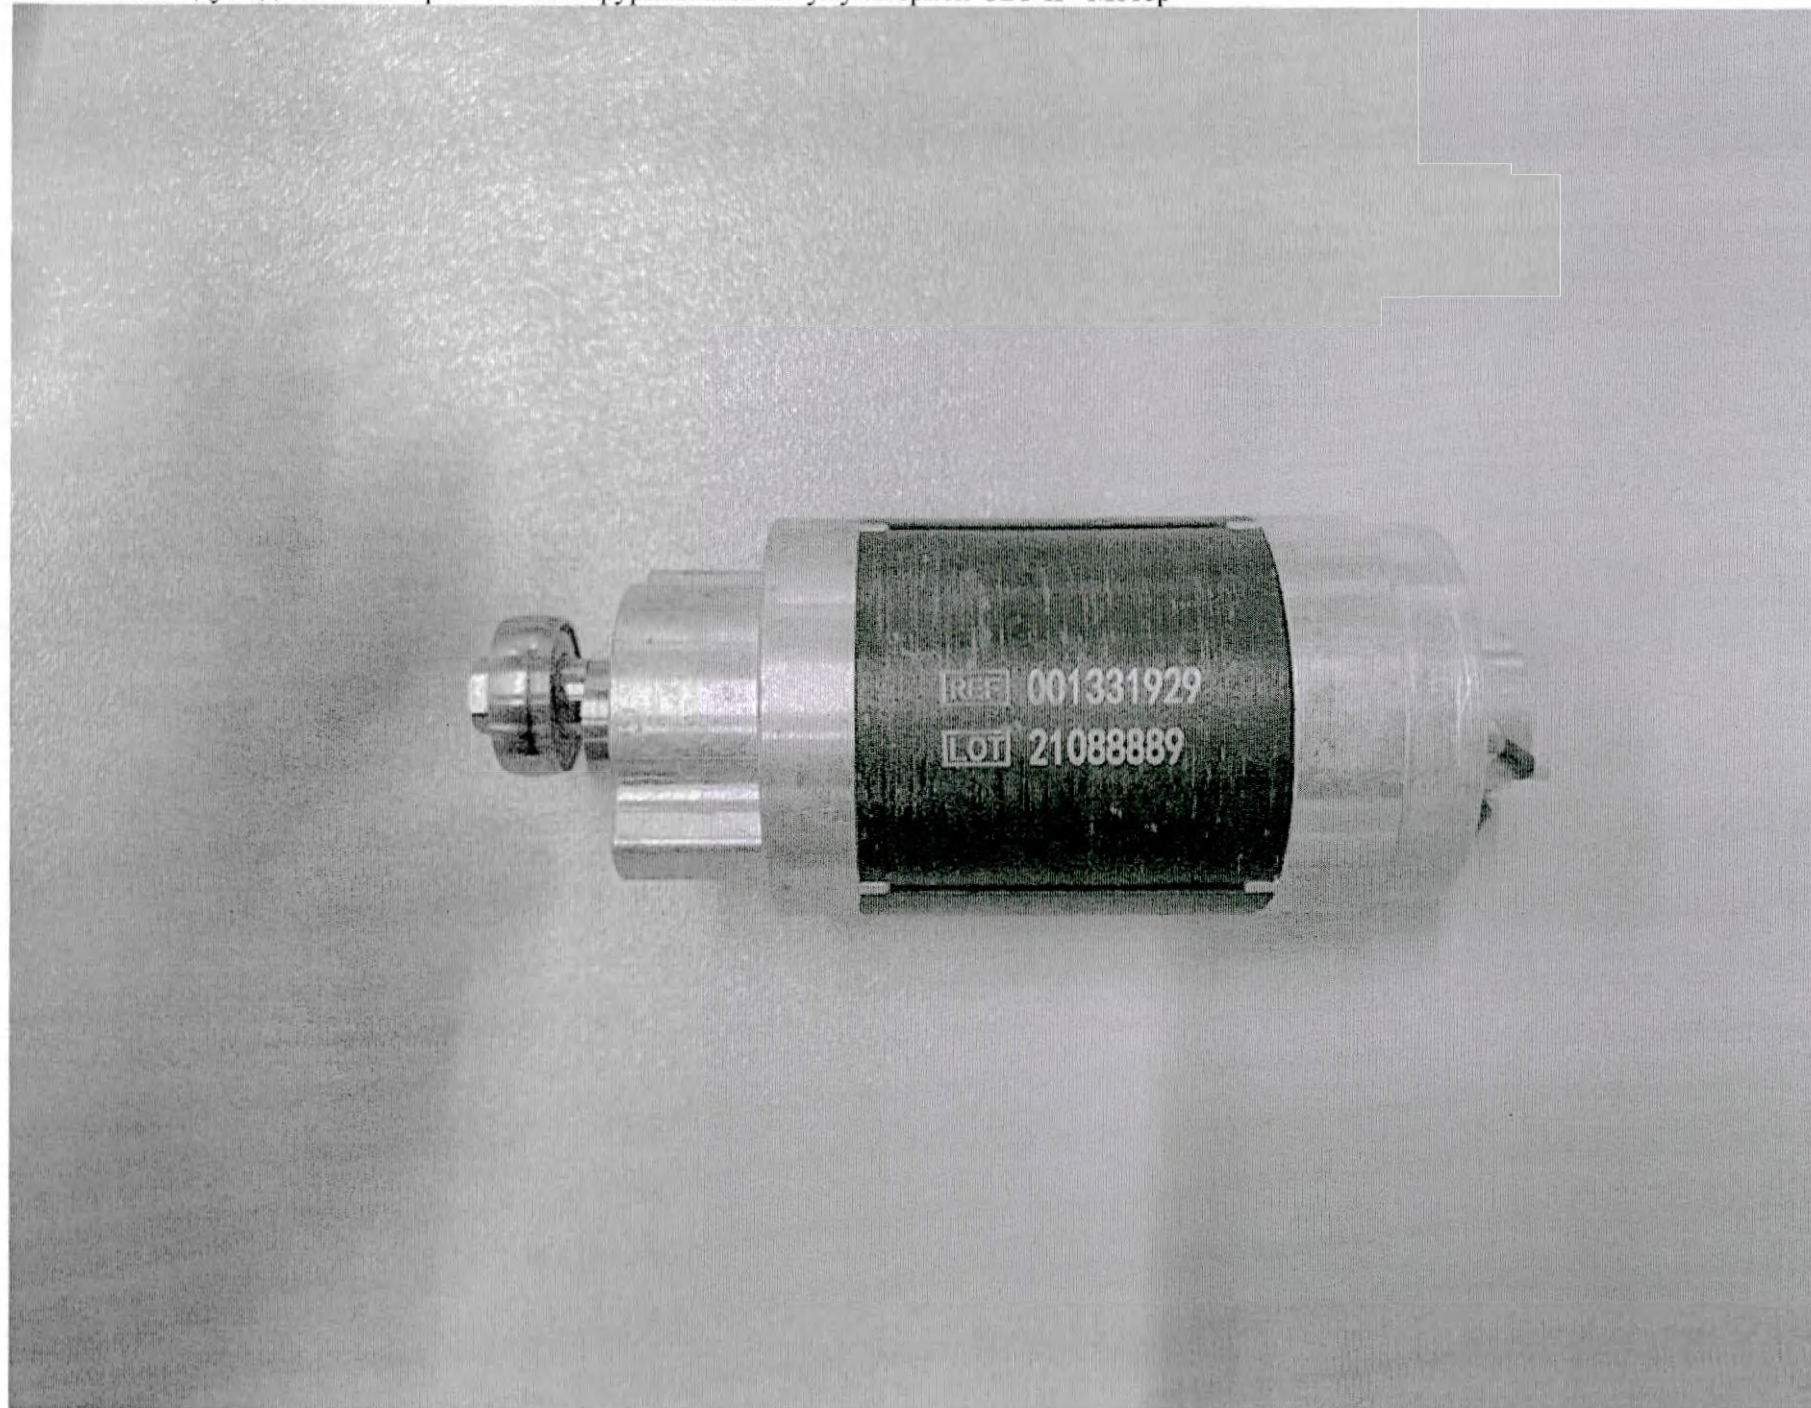

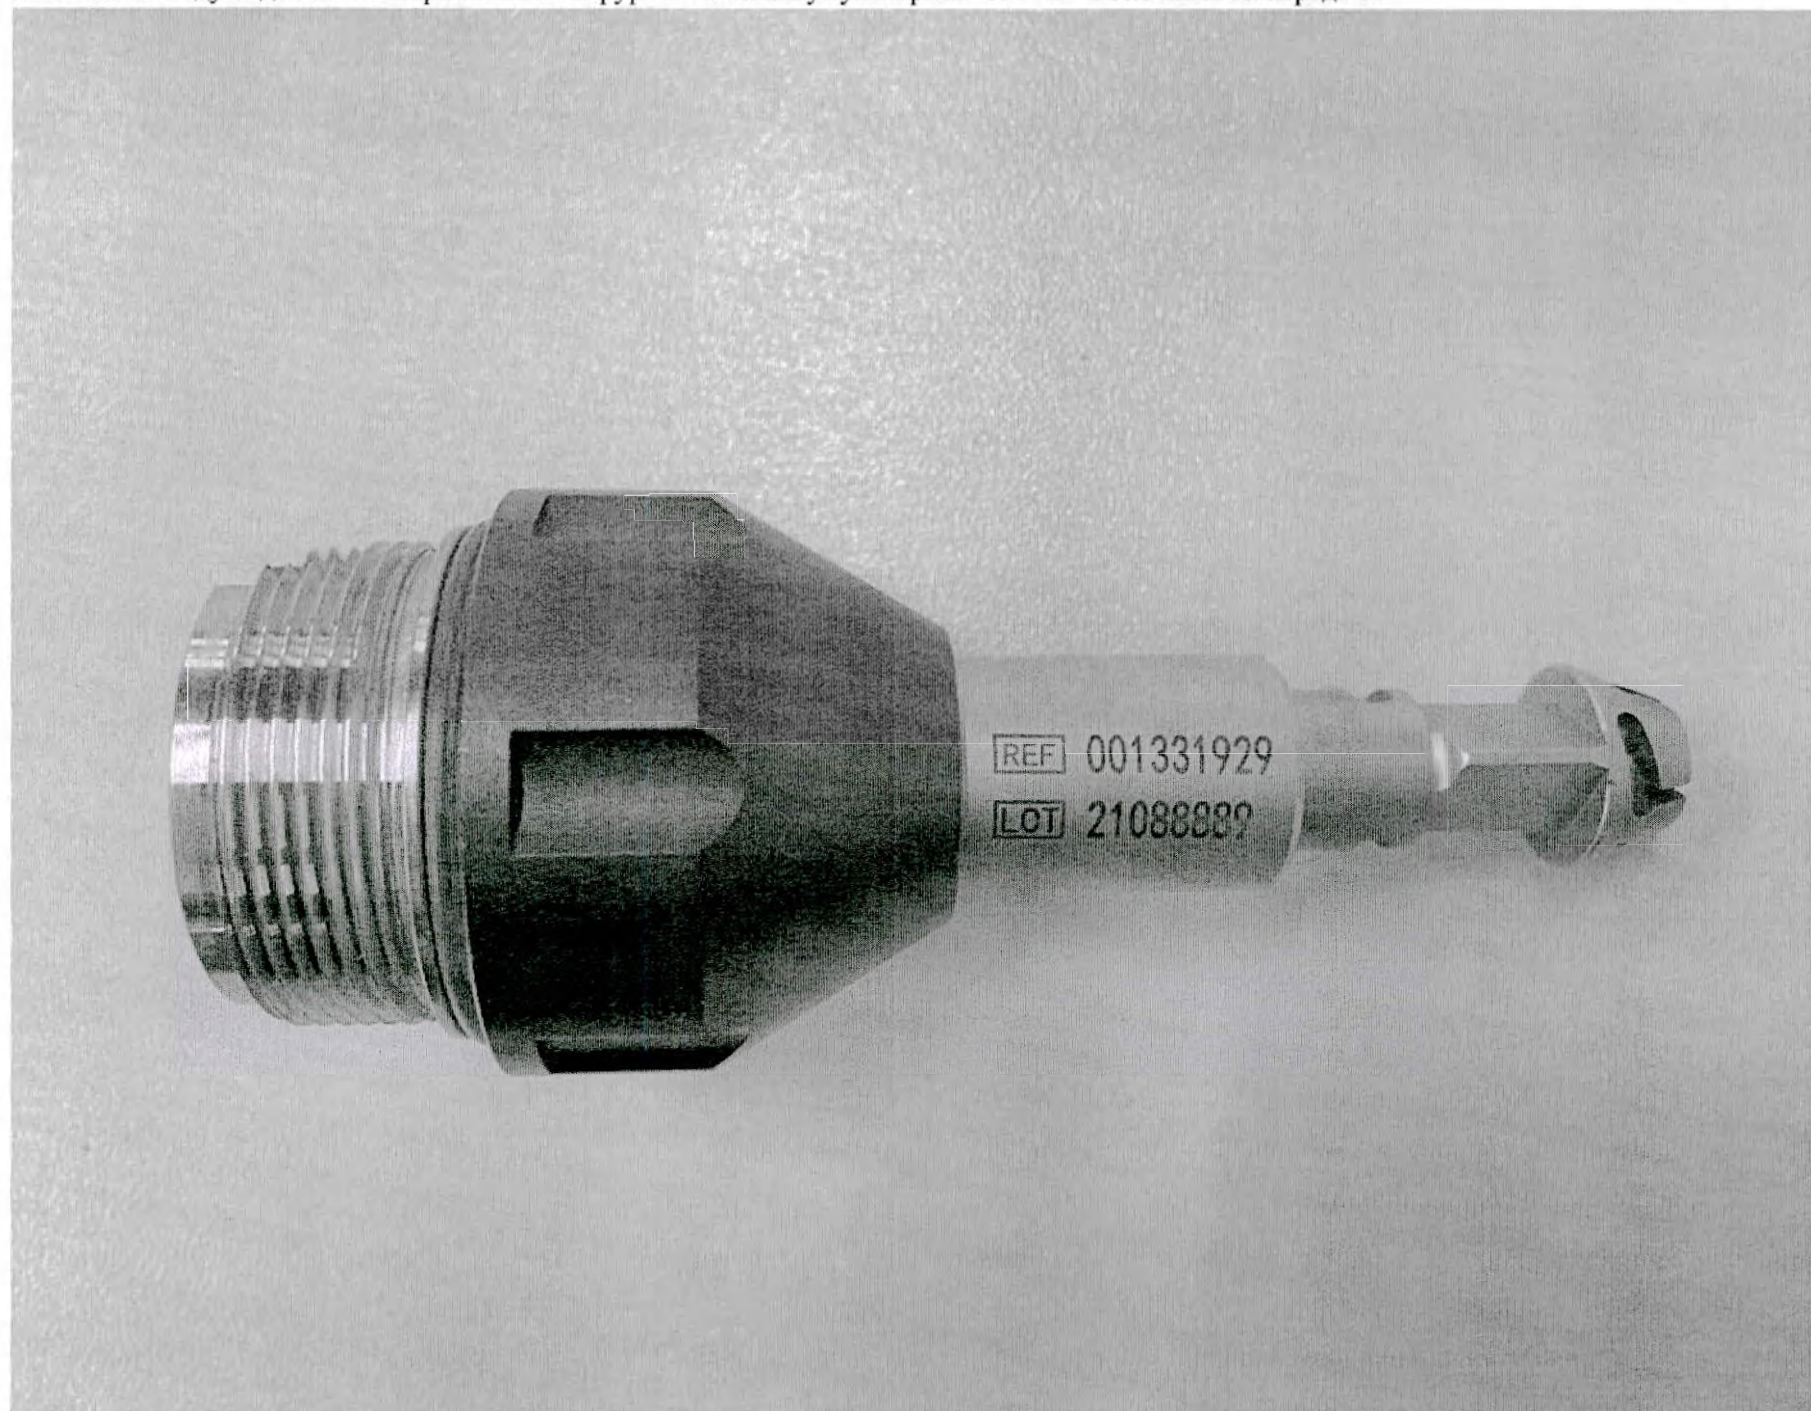


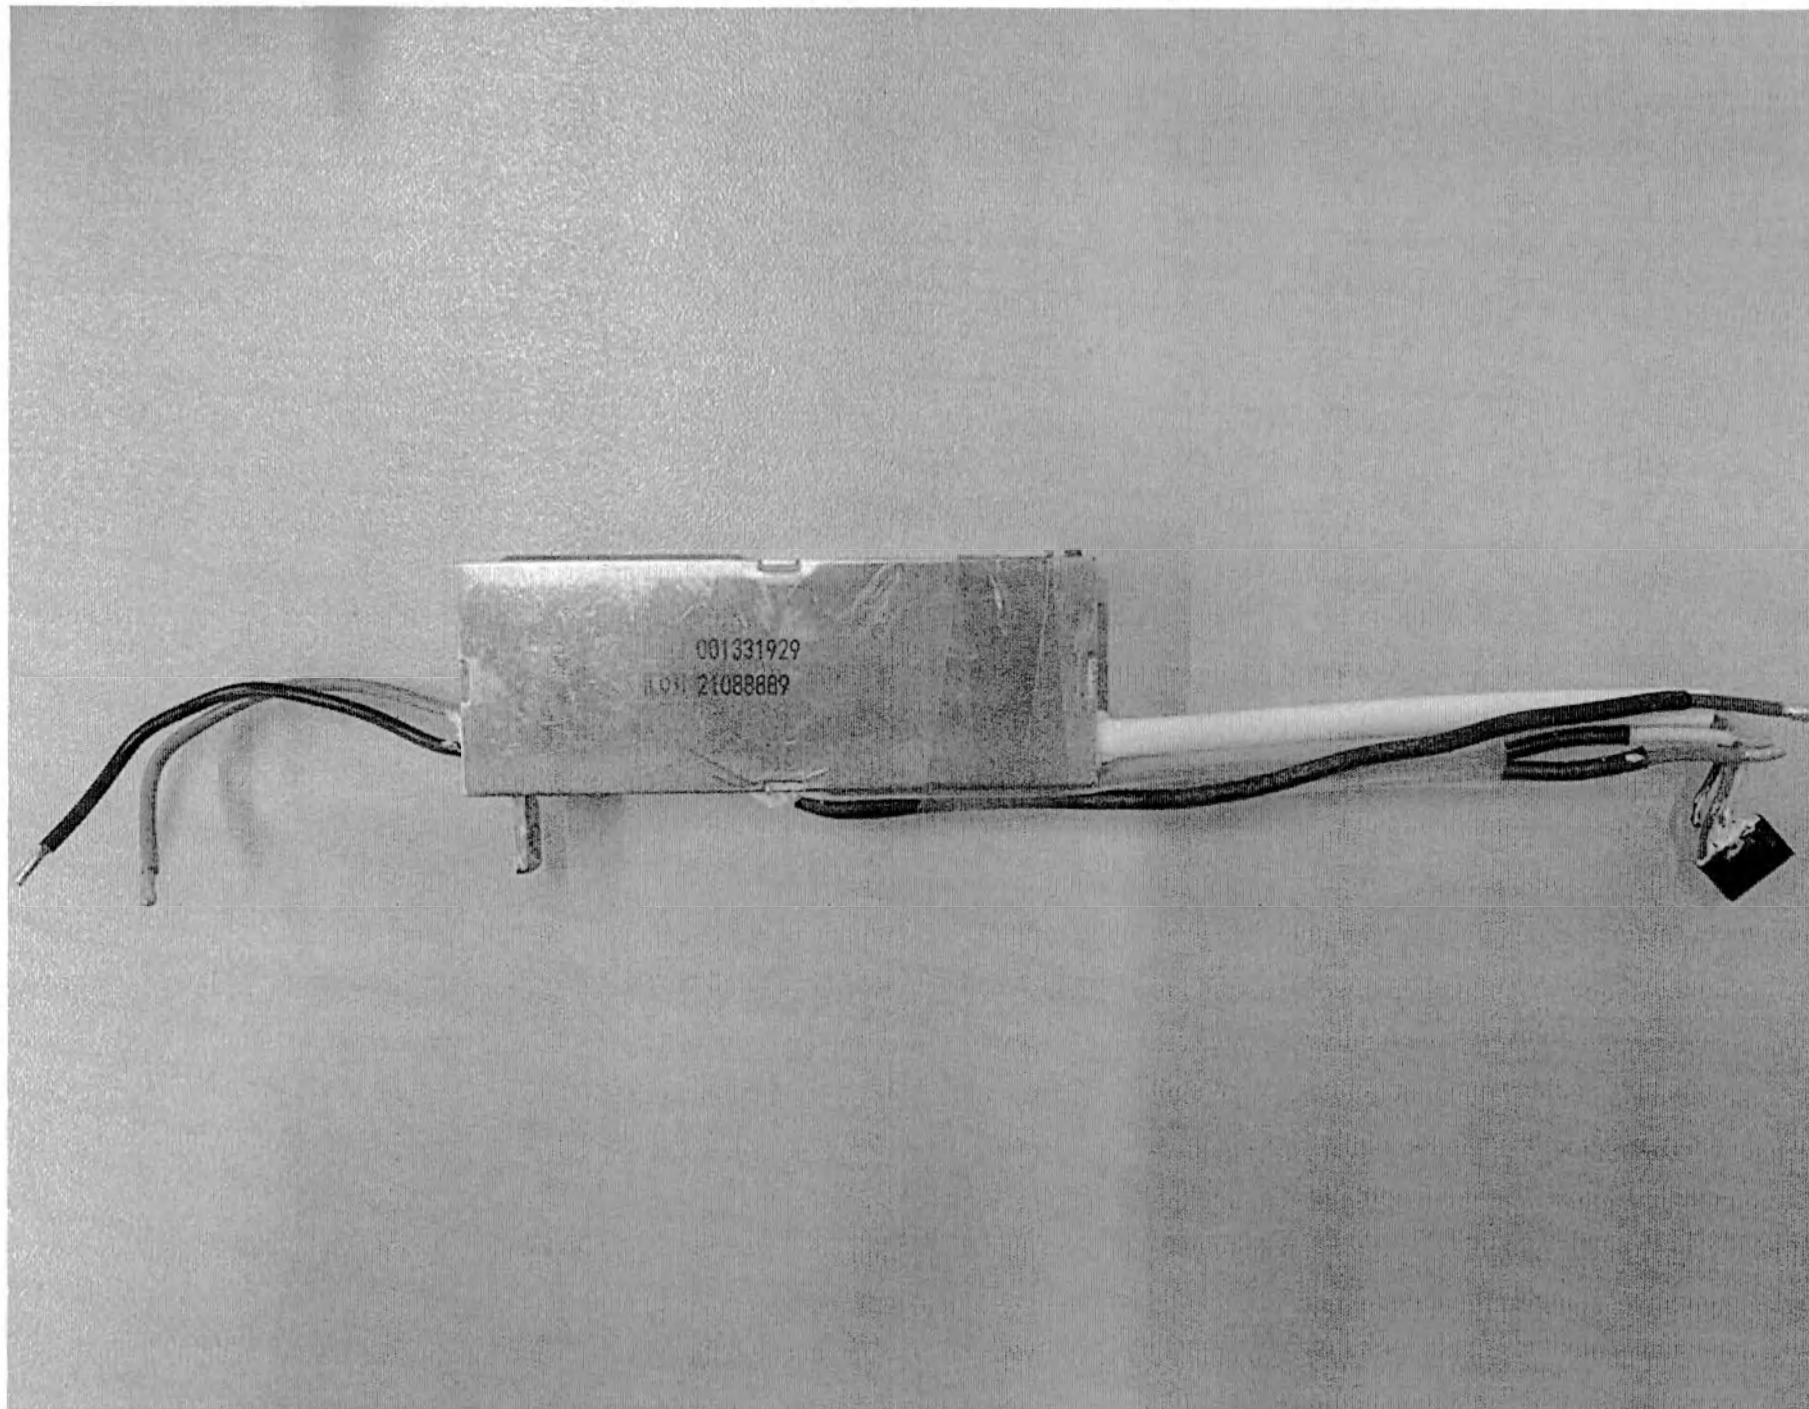


Контейнер стерилизационный для оборудования хирургического для обработки костной ткани GDP

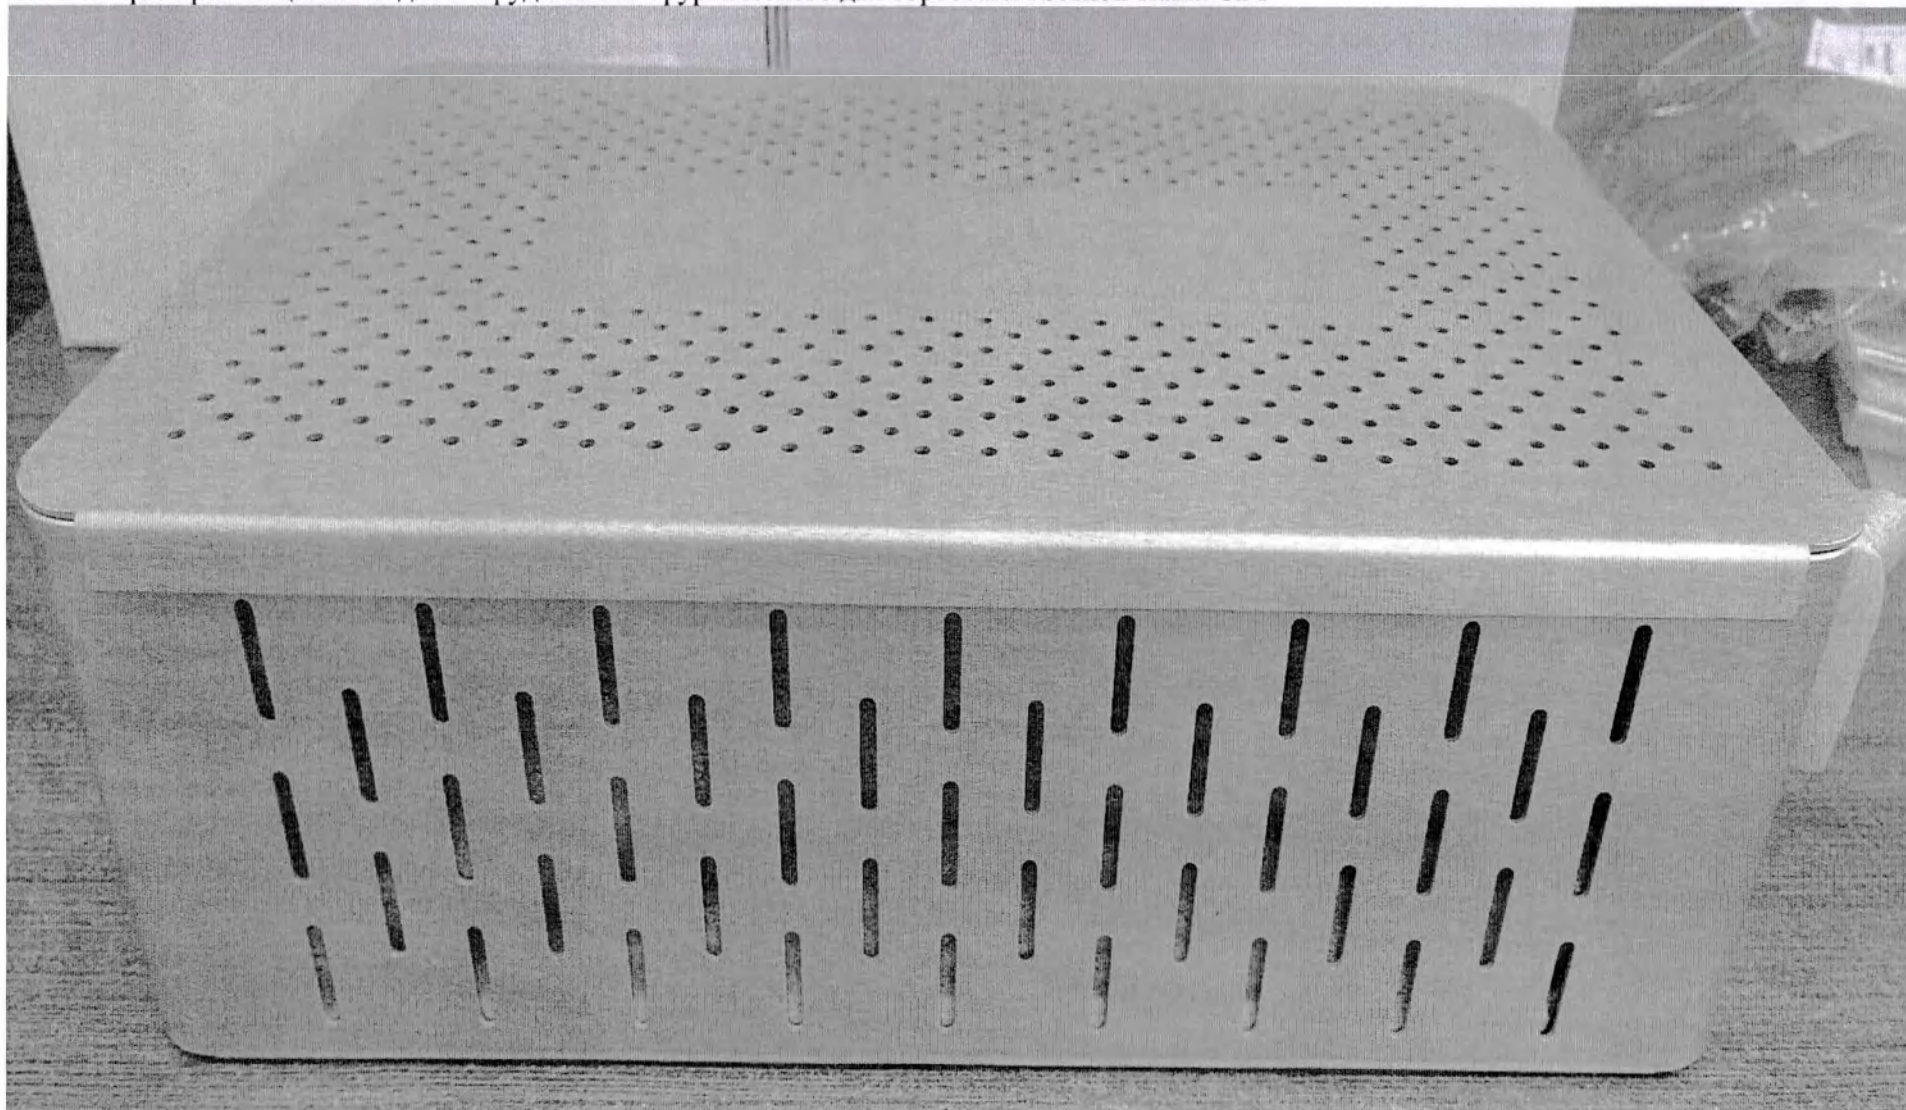

Вставной лоток контейнера стерилизационного для оборудования хирургического для обработки костной ткани GDP

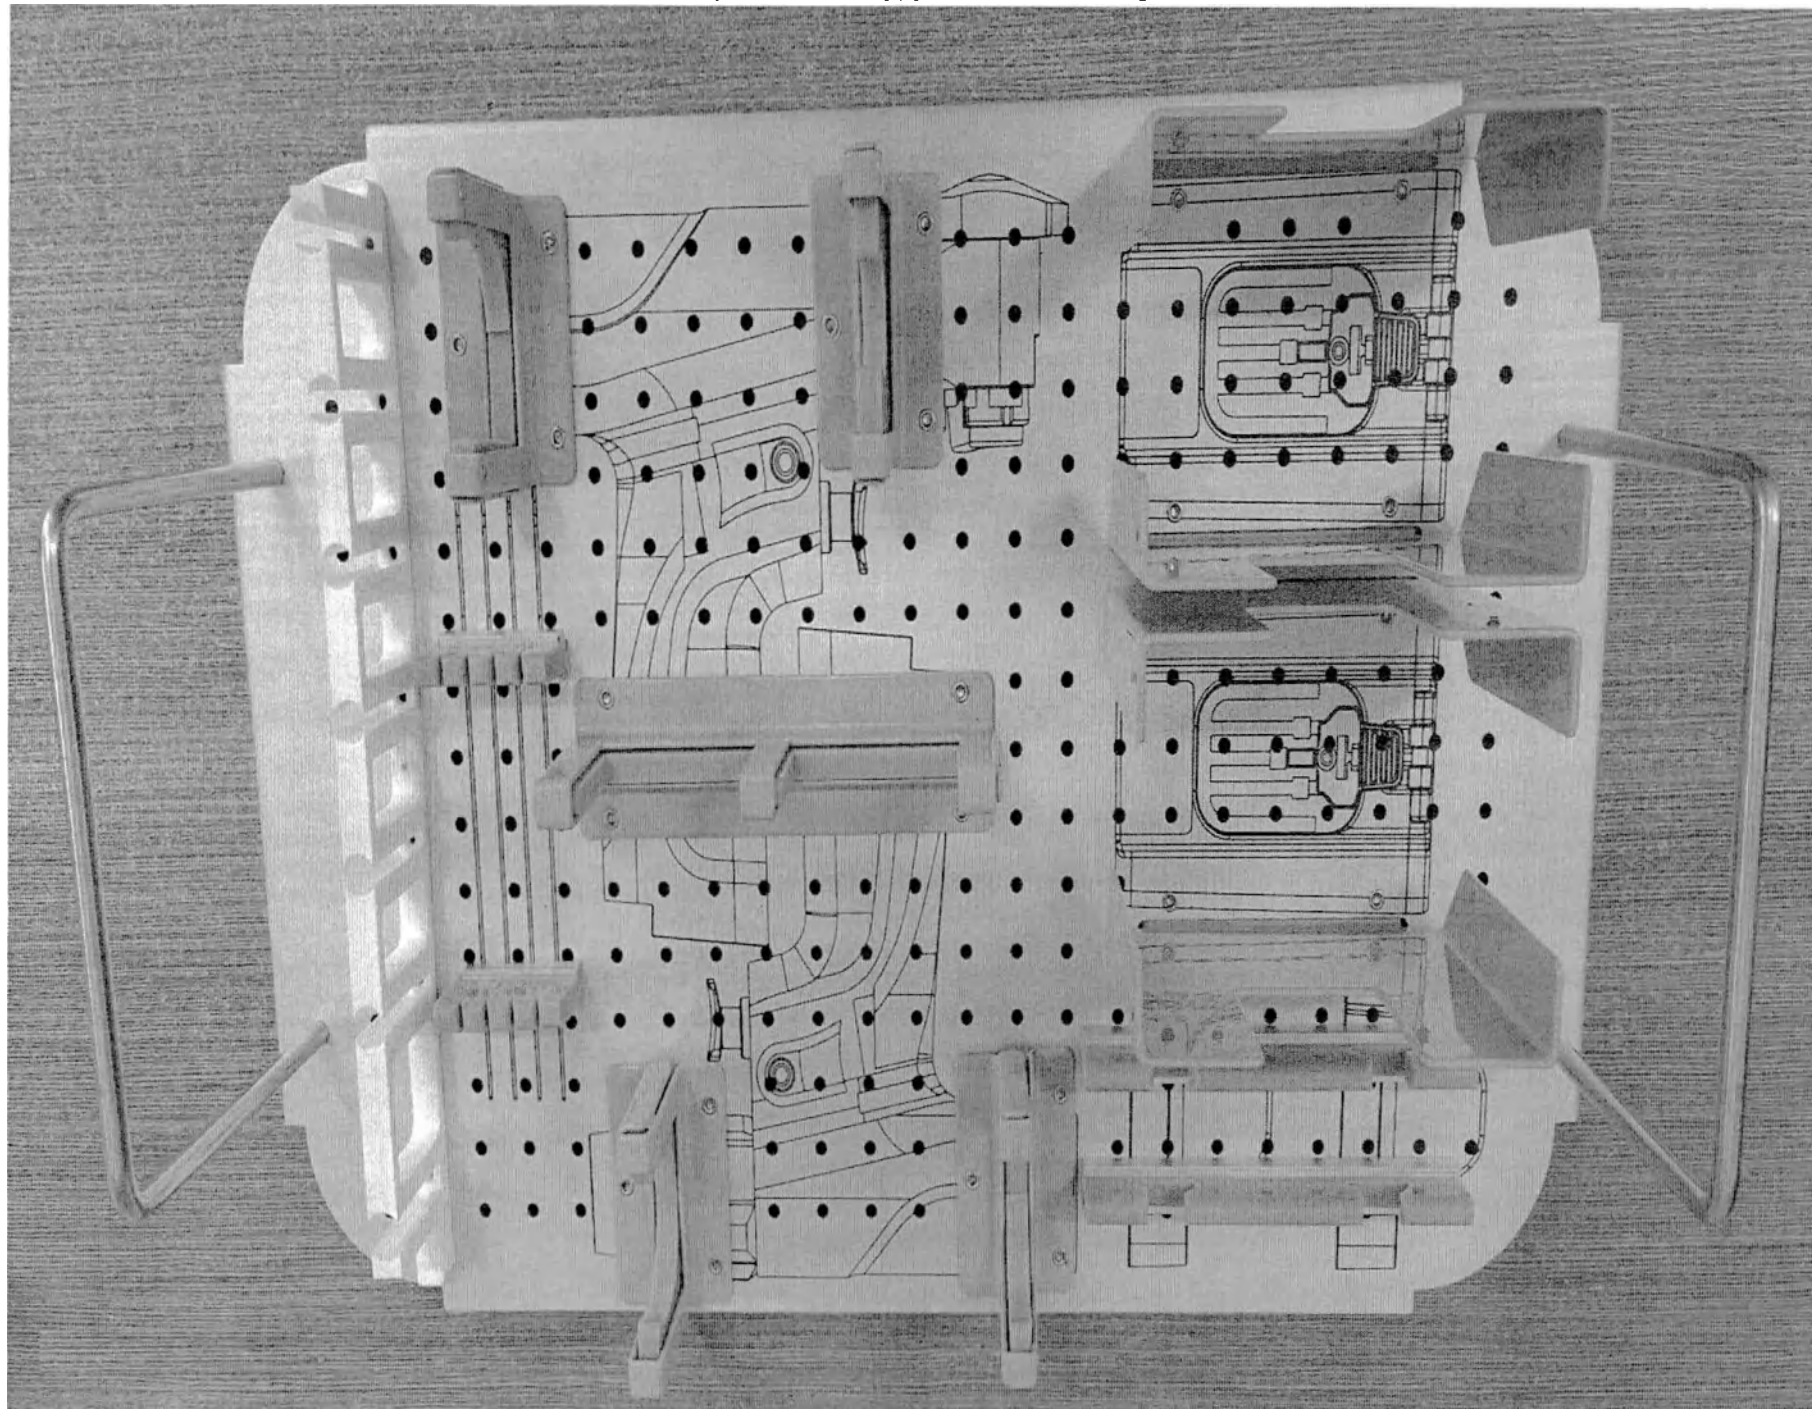

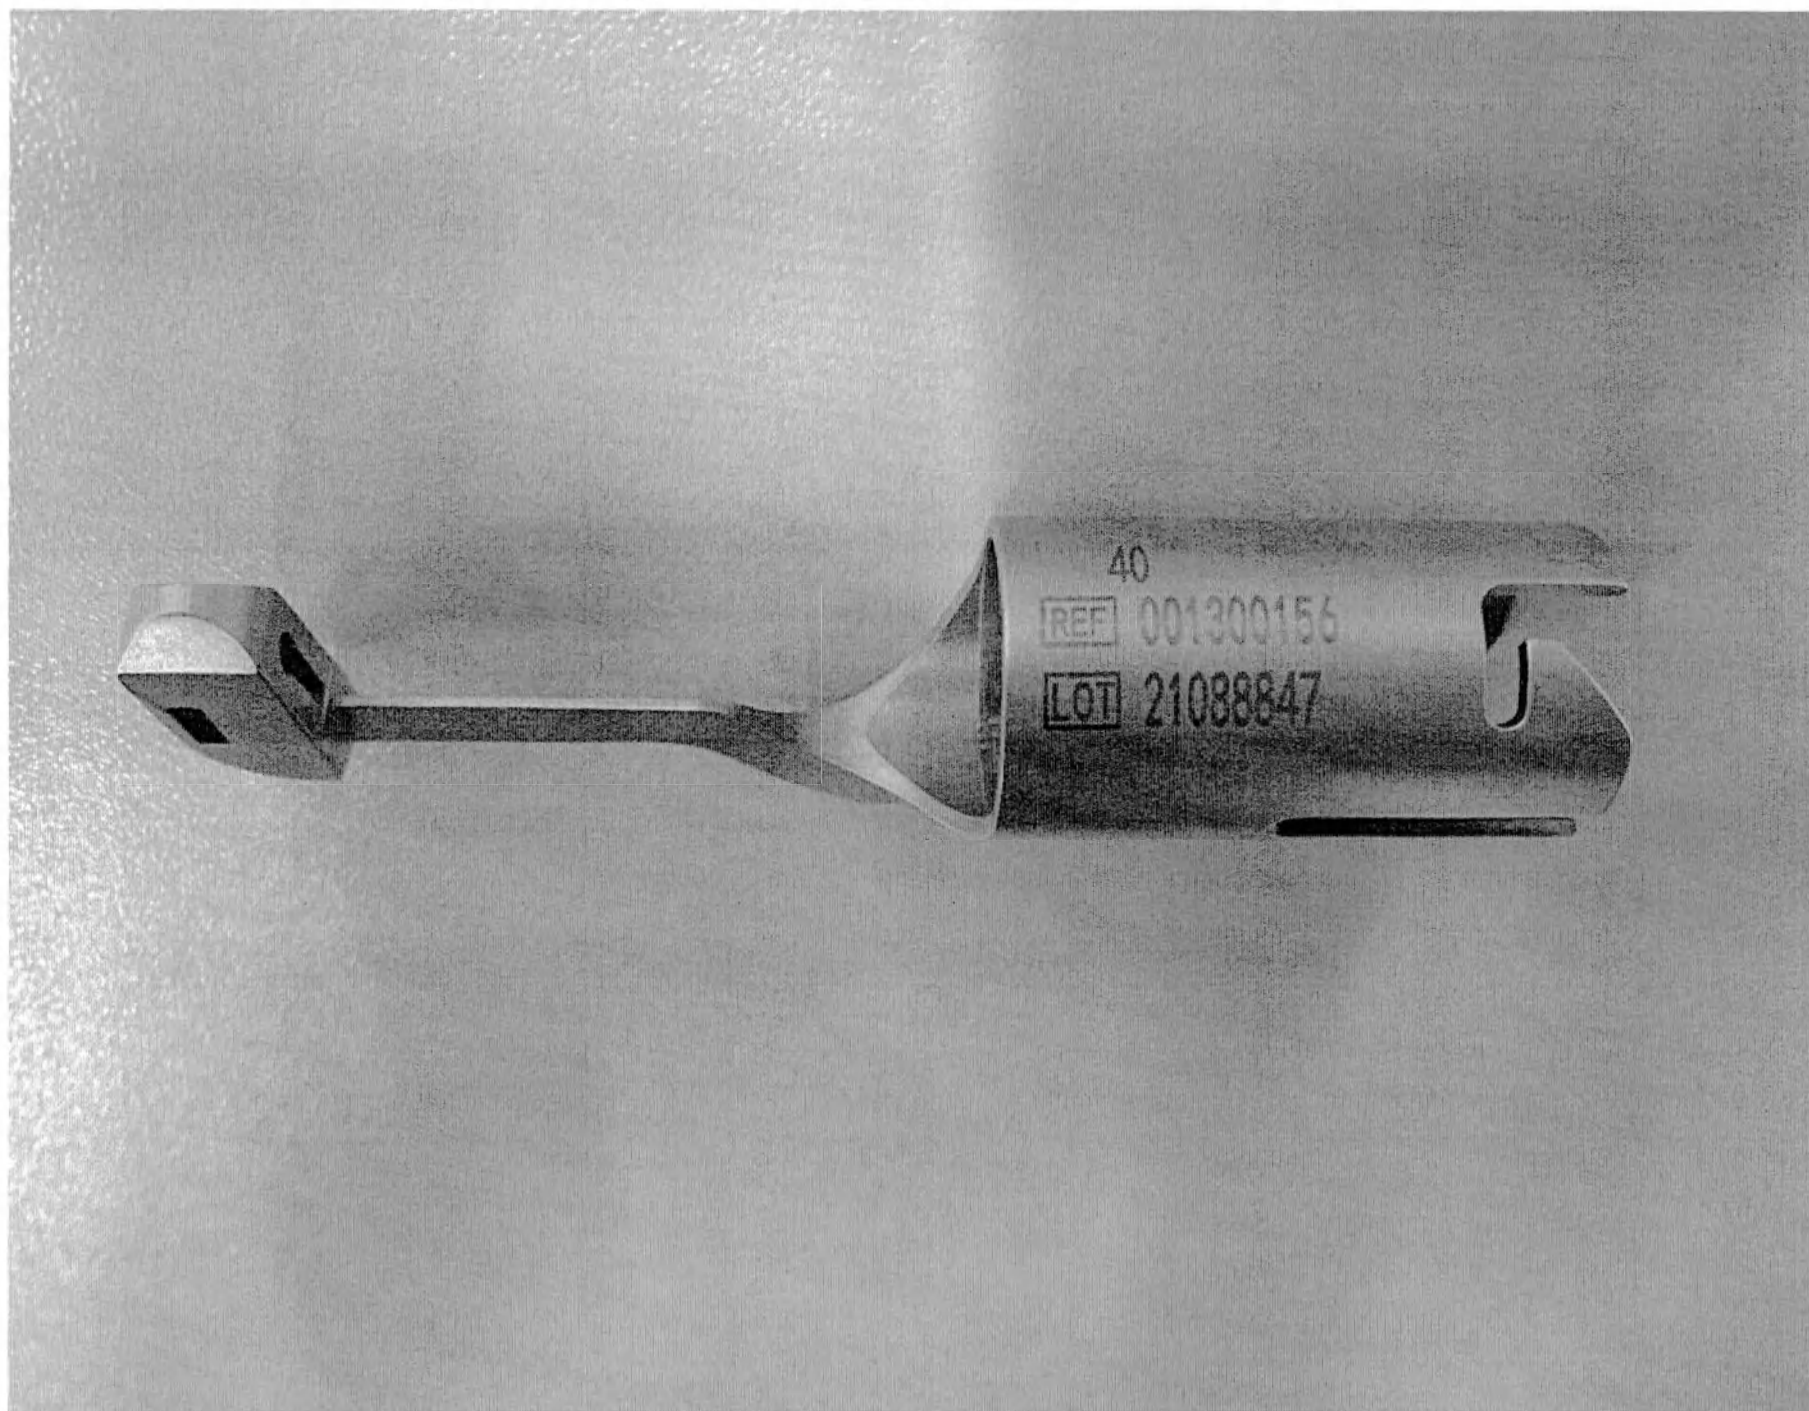

Проект текста маркировки для обращения на территории Российской Федерации

Серийный №	Наименование
001300131	Пила стернотомная хирургическая аккумуляторная GDP II Наименование медицинского изделия: Пила стернотомная хирургическая аккумуляторная GDP II Модель продукта: GDP II Код продукта: 001300131 Рабочий цикл: 60 сек. ВКЛ., 240 сек. ВЫКЛ. x 5 Наименование производителя: SUZHOU AND SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP. (СУЧЖОУ ЭНД САЙЕНС & ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.) Юридический адрес производителя: No. 2, ANSHENG ROAD, JINFENG TOWN, 215625 ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R.CHINA (Китай) Ответственный уполномоченный представитель в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, корпус 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11 Условия хранения и транспортировки: от -40 °C до +55 °C Код партии (серии): см. упаковку Год выпуска: см. упаковку Нестерильно! Нетоксично! Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX
001300137	Зарядное устройство на два гнезда для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Наименование медицинского изделия: Зарядное устройство на два гнезда для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Код продукта: 001300137 Наименование производителя: SUZHOU AND SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP. (СУЧЖОУ ЭНД САЙЕНС & ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.) Юридический адрес производителя: No. 2, ANSHENG ROAD, JINFENG TOWN, 215625 ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R.CHINA (Китай) Ответственный уполномоченный представитель в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, корпус 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11 Условия хранения и транспортировки: от -40 °C до +55 °C Код партии (серии): см. упаковку Год выпуска: см. упаковку Нестерильно! Нетоксично! Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

001300135	Батарея аккумуляторная большая (2200 мАч) для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Наименование медицинского изделия: Батарея аккумуляторная большая (2200 мАч) для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Код продукта: 001300135 Наименование производителя: SUZHOU AND SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP. (СУЧЖОУ ЭНД САЙЕНС & ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.) Юридический адрес производителя: No. 2, ANSHENG ROAD, JINFENG TOWN, 215625 ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R.CHINA (Китай) Ответственный уполномоченный представитель в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, корпус 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11 Условия хранения и транспортировки: от -20 °С до +45 °С Код партии (серии): см. упаковку Год выпуска: см. упаковку Нестерильно! Нетоксично! Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX  
001300136	Батарея аккумуляторная малая (1100 мАч) для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Наименование медицинского изделия: Батарея аккумуляторная малая (1100 мАч) для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Наименование производителя: SUZHOU AND SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP. (СУЧЖОУ ЭНД САЙЕНС & ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.) Юридический адрес производителя: No. 2, ANSHENG ROAD, JINFENG TOWN, 215625 ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R.CHINA (Китай) Ответственный уполномоченный представитель в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, корпус 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11 Условия хранения и транспортировки: от -20 °С до +45 °С Код партии (серии): см. упаковку Год выпуска: см. упаковку Нестерильно! Нетоксично! Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX  

001370056	Лезвие для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Наименование медицинского изделия: Лезвие для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II размером: 6 x 0,6 x 40 мм Код продукта: см. упаковку Наименование производителя: SUZHOU AND SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP. (СУЧЖОУ ЭНД САЙЕНС & ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.) Юридический адрес производителя: No. 2, ANSHENG ROAD, JINFENG TOWN, 215625 ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R.CHINA (Китай) Ответственный уполномоченный представитель в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, корпус 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11 Условия хранения: от -40 °С до +50 °С Код партии (серии): см. упаковку Год выпуска: см. упаковку Нестерильно! Нетоксично! Изготовлено из нержавеющей стали «Н» Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX 
001300159	Чехол для батареи большой для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Наименование медицинского изделия: Чехол для батареи большой для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Наименование производителя: SUZHOU AND SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP. (СУЧЖОУ ЭНД САЙЕНС & ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.) Юридический адрес производителя: No. 2, ANSHENG ROAD, JINFENG TOWN, 215625 ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R.CHINA (Китай) Ответственный уполномоченный представитель в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, корпус 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11 Условия хранения и транспортировки: от -40 °С до +55 °С Код партии (серии): см. упаковку Год выпуска: см. упаковку Нестерильно! Нетоксично! Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX 

001300160	Чехол для батареек малый для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Наименование медицинского изделия: Чехол для батареек малый для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Наименование производителя: SUZHOU ANI SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP. (СУЧЖОУ ЭНД САЙЕНС & ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.) Юридический адрес производителя: No. 2, ANSHENG ROAD, JINFENG TOWN, 215625 ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R.CHINA (Китай) Ответственный уполномоченный представитель в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, корпус 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11 Условия хранения и транспортировки: от -40 °С до +55 °С Код партии (серии): см. упаковку Год выпуска: см. упаковку Нестерильно! Нетоксично! Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX 
001300161	Канал стерилизационный большой для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Наименование медицинского изделия: Канал стерилизационный большой для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Наименование производителя: SUZHOU AND SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP. (СУЧЖОУ ЭНД САЙЕНС & ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.) Юридический адрес производителя: No. 2, ANSHENG ROAD, JINFENG TOWN, 215625 ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R.CHINA (Китай) Ответственный уполномоченный представитель в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, корпус 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11 Условия хранения и транспортировки: от -40 °С до +55 °С Код партии (серии): Год выпуска: Нестерильно! Нетоксично! Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX 

001300162	Канал стерилизационный малый для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Наименование медицинского изделия: Канал стерилизационный малый для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Наименование производителя: SUZHOU AND SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP. (СУЧЖОУ ЭНД САЙЕНС & ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.) Юридический адрес производителя: No. 2, ANSHENG ROAD, JINFENG TOWN, 215625 ZIJIANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R.CHINA (Китай) Ответственный уполномоченный представитель в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, корпус 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11 Условия хранения и транспортировки: от -40 °С до +55 °С Код партии (серии): см. упаковку Год выпуска: см. упаковку Нестерильно! Нетоксично! Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX 
001331929	Ремонтный модуль для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Наименование медицинского изделия: Ремонтный модуль для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Наименование производителя: SUZHOU AND SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP. (СУЧЖОУ ЭНД САЙЕНС & ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.) Юридический адрес производителя: No. 2, ANSHENG ROAD, JINFENG TOWN, 215625 ZIJIANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R.CHINA (Китай) Ответственный уполномоченный представитель в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, корпус 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11 Условия хранения и транспортировки: от -40 °С до +55 °С Код партии (серии): см. упаковку Год выпуска: см. упаковку Нестерильно! Нетоксично! Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX 

001372201	Контейнер стерилизационный для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Наименование медицинского изделия: Контейнер стерилизационный для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Наименование производителя: SUZHOU AND SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP. (СУЧЖОУ ЭНД САЙЕНС & ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.) Юридический адрес производителя: No. 2, ANSHENG ROAD, JINFENG TOWN, 215625 ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R.CHINA (Китай) Ответственный уполномоченный представитель в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, корпус 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11 Условия хранения и транспортировки: от -40 °C до +55 °C Код партии (серии): см. упаковку Год выпуска: см. упаковку Нестерильно! Нетоксично! Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX 
001300156	Ограничитель лезвия для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Наименование медицинского изделия: Ограничитель лезвия для пилы стернотомной хирургической аккумуляторной GDP II Наименование производителя: SUZHOU AND SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORP. (СУЧЖОУ ЭНД САЙЕНС & ТЕХНОЛОДЖИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРП.) Юридический адрес производителя: No. 2, ANSHENG ROAD, JINFENG TOWN, 215625 ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, P.R.CHINA (Китай) Ответственный уполномоченный представитель в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, г. Москва, Шмитовский проезд, дом 39, корпус 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11 Условия хранения и транспортировки: от -40 °C до +55 °C Код партии (серии): см. упаковку Год выпуска: см. упаковку Нестерильно! Нетоксично! Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX 

Прошито и пронумеровано
29 (двадцать девять) листов

Генеральный директор
И. Козлов

