

УТВЕРЖДАЮ

Общество с ограниченной ответственностью

«ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ»

Генеральный директор

Татаринов А.М.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ «ИМПЛАНТАТ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ
ВНУТРИКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ REFINEX В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ»**



Рис. 1. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны картонной коробки Refinex Contour

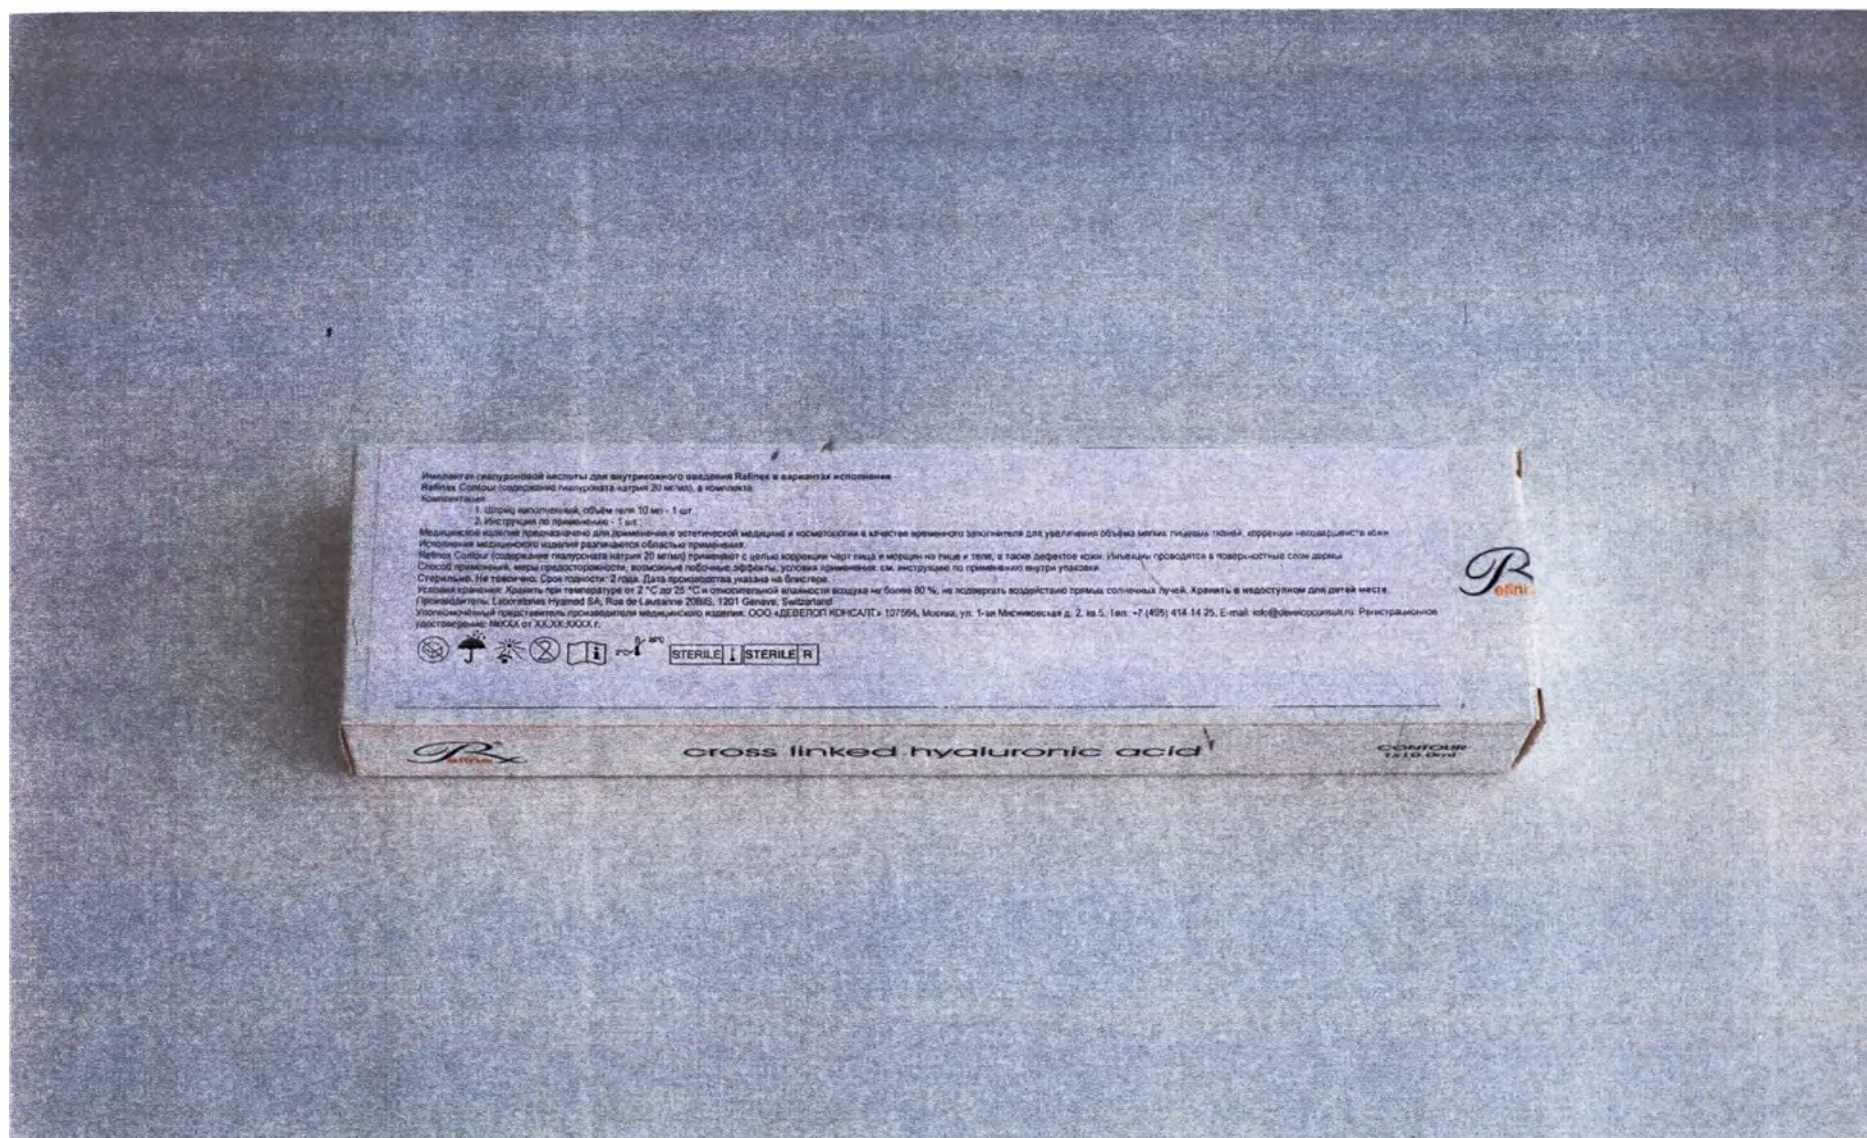


Рис. 2. На фотографии приведен общий вид оборотной стороны картонной коробки Refinex Contour

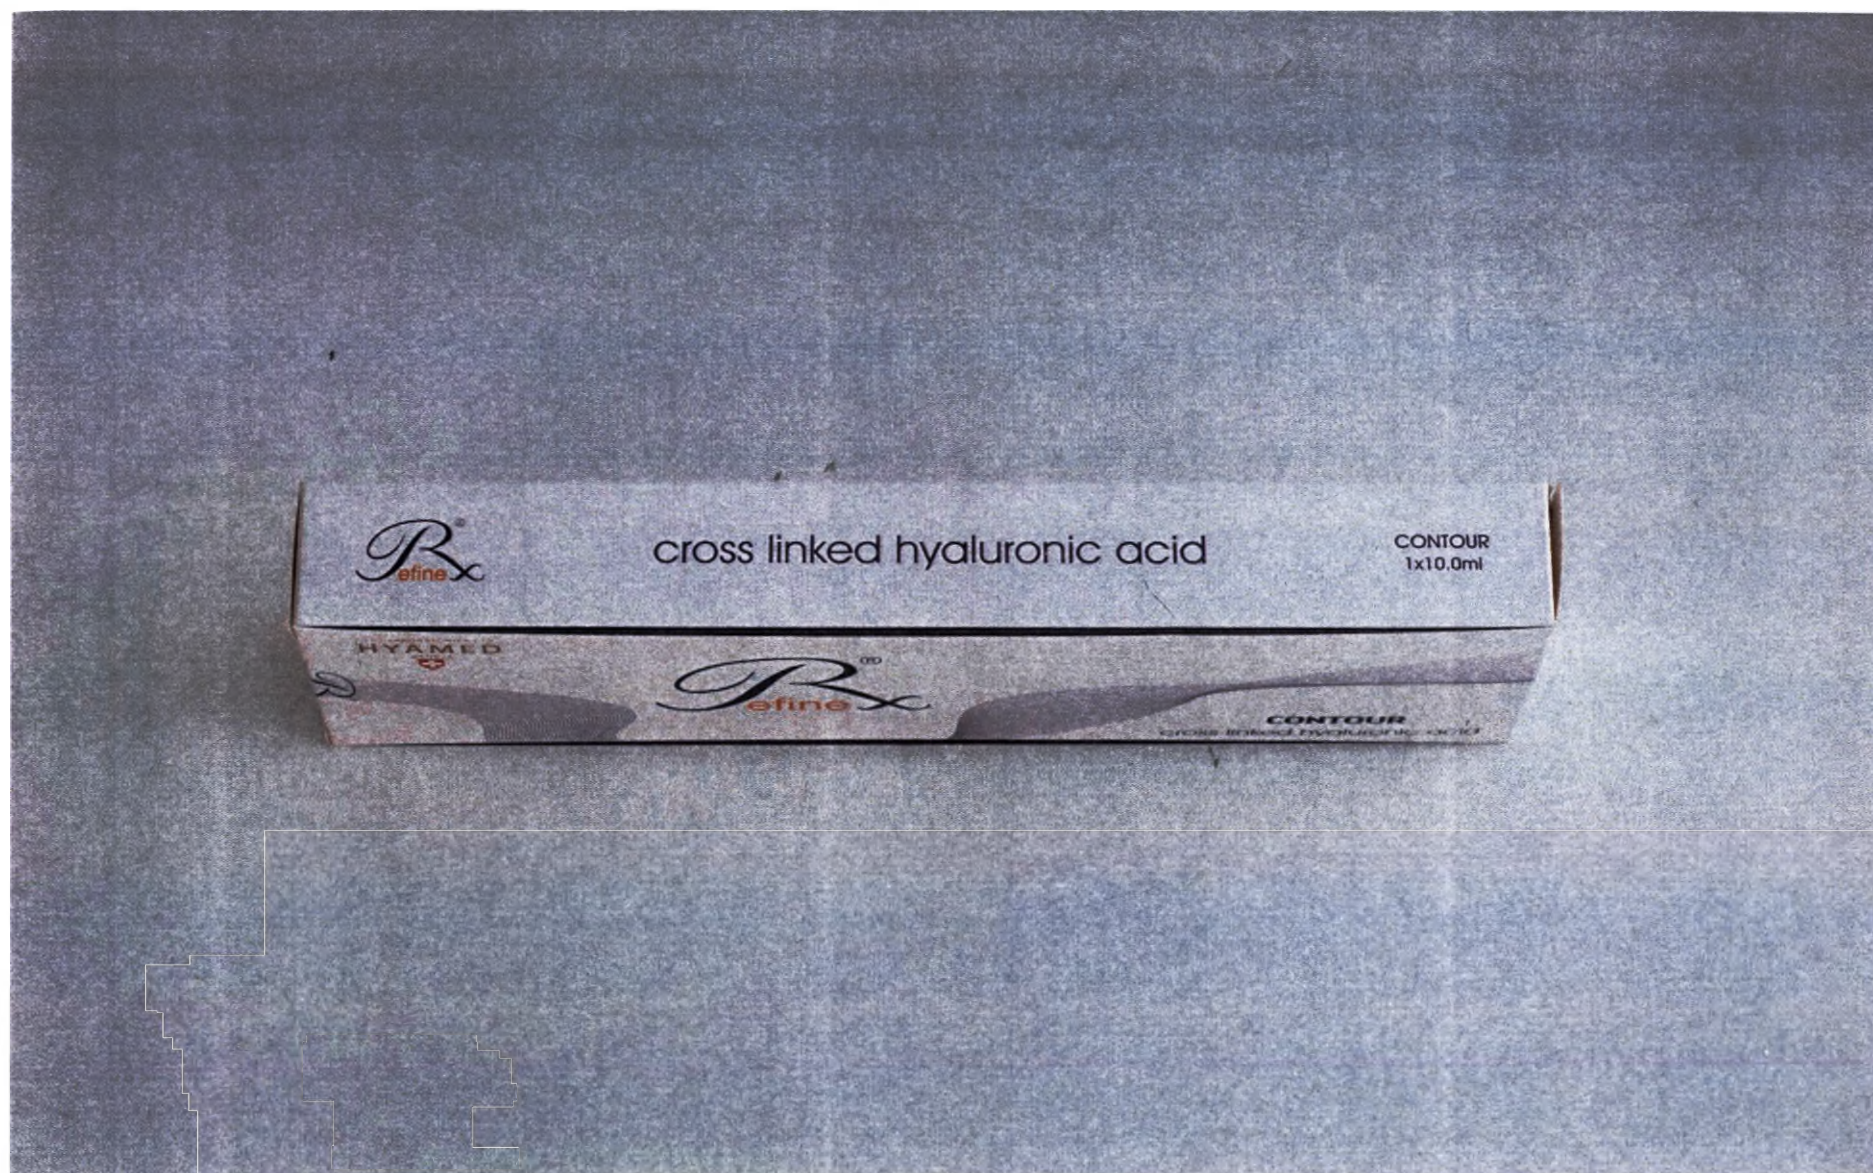


Рис. 3. На фотографии приведен общий вид боковой стороны картонной коробки Refinex Contour

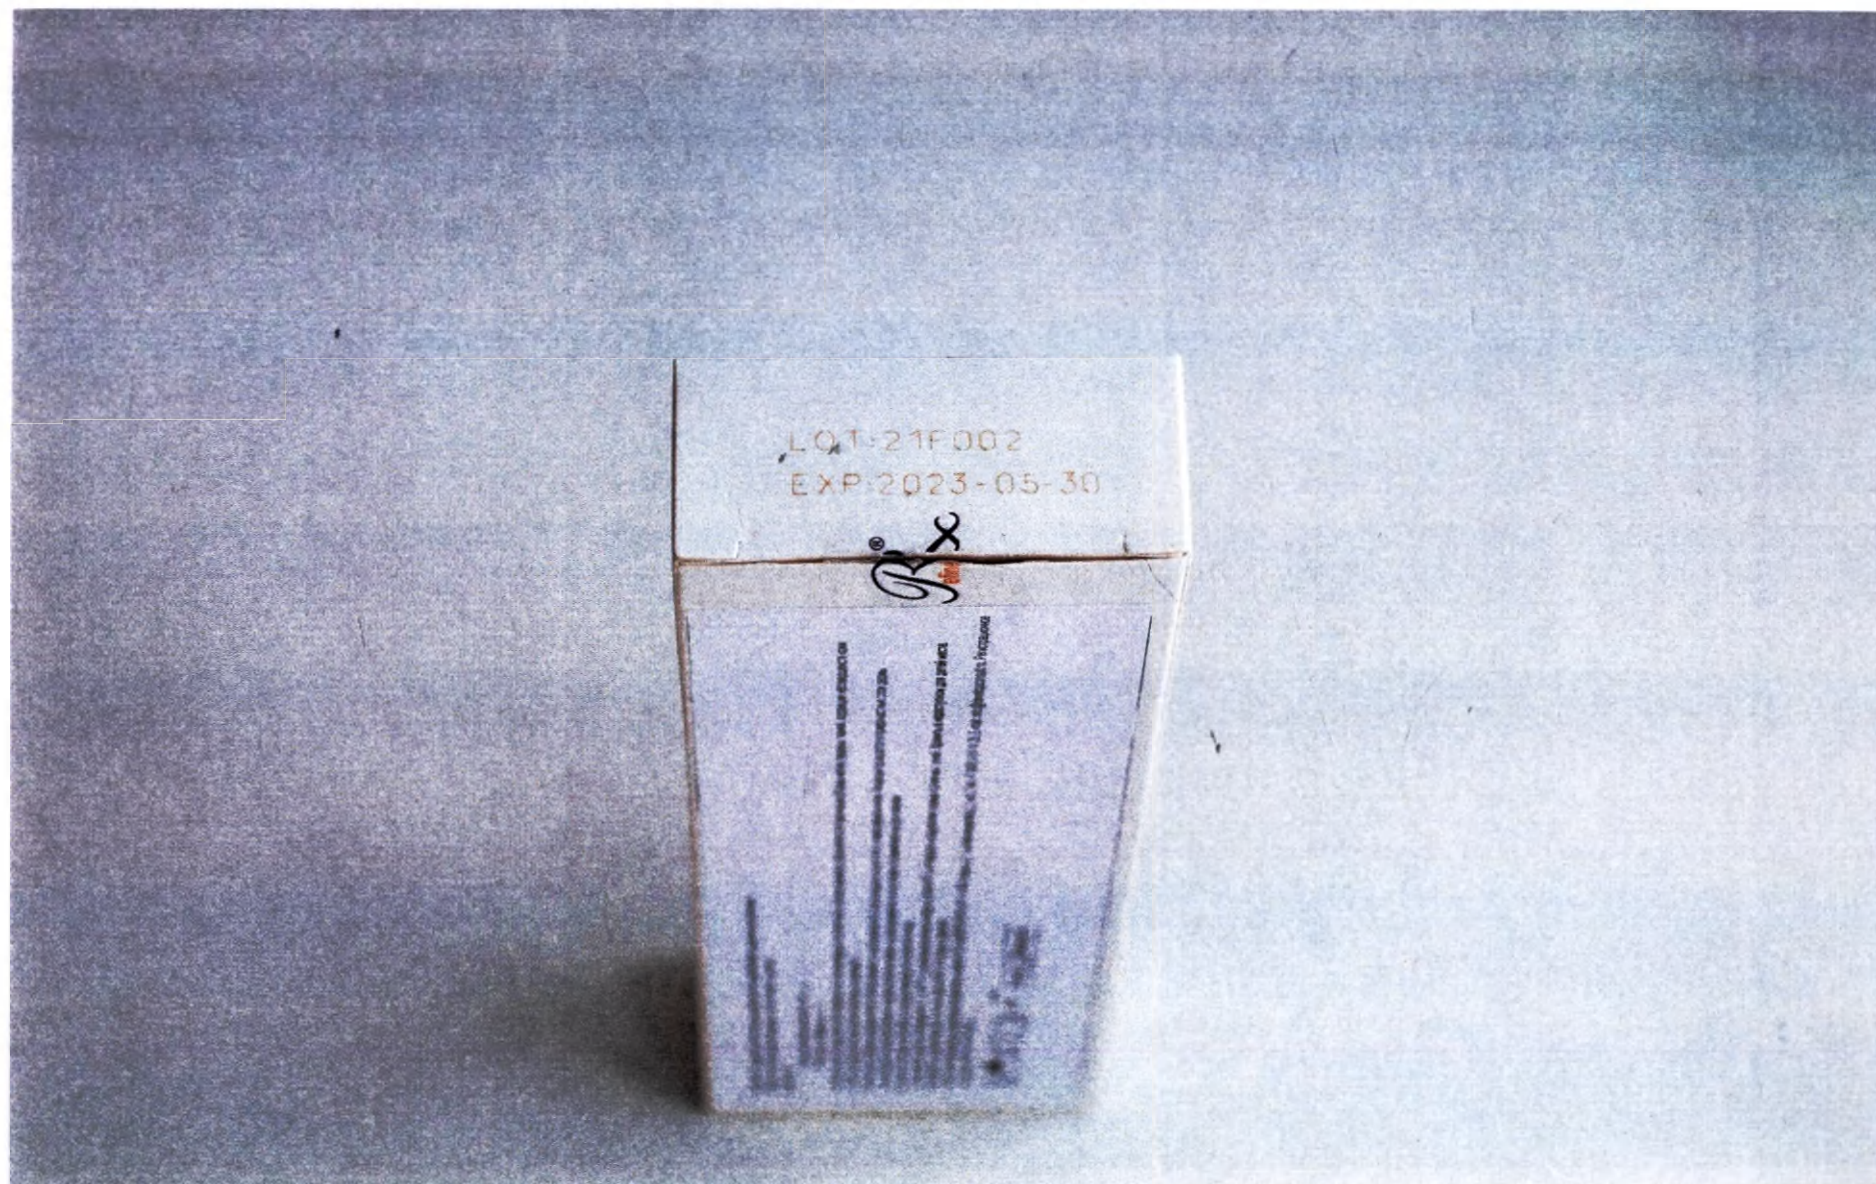


Рис. 4. На фотографии приведен общий вид боковой стороны картонной коробки Refinex Contour



Рис. 5. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны картонной коробки Refinex Extra Deep

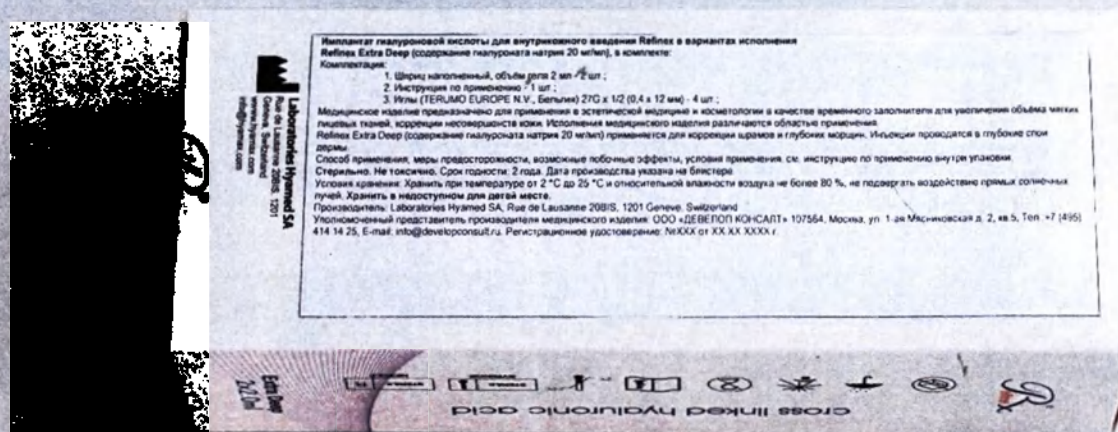


Рис. 6. На фотографии приведен общий вид оборотной стороны картонной коробки Refinex Extra Deep



Рис. 7. На фотографии приведен общий вид боковой стороны картонной коробки Refinex Extra Deep

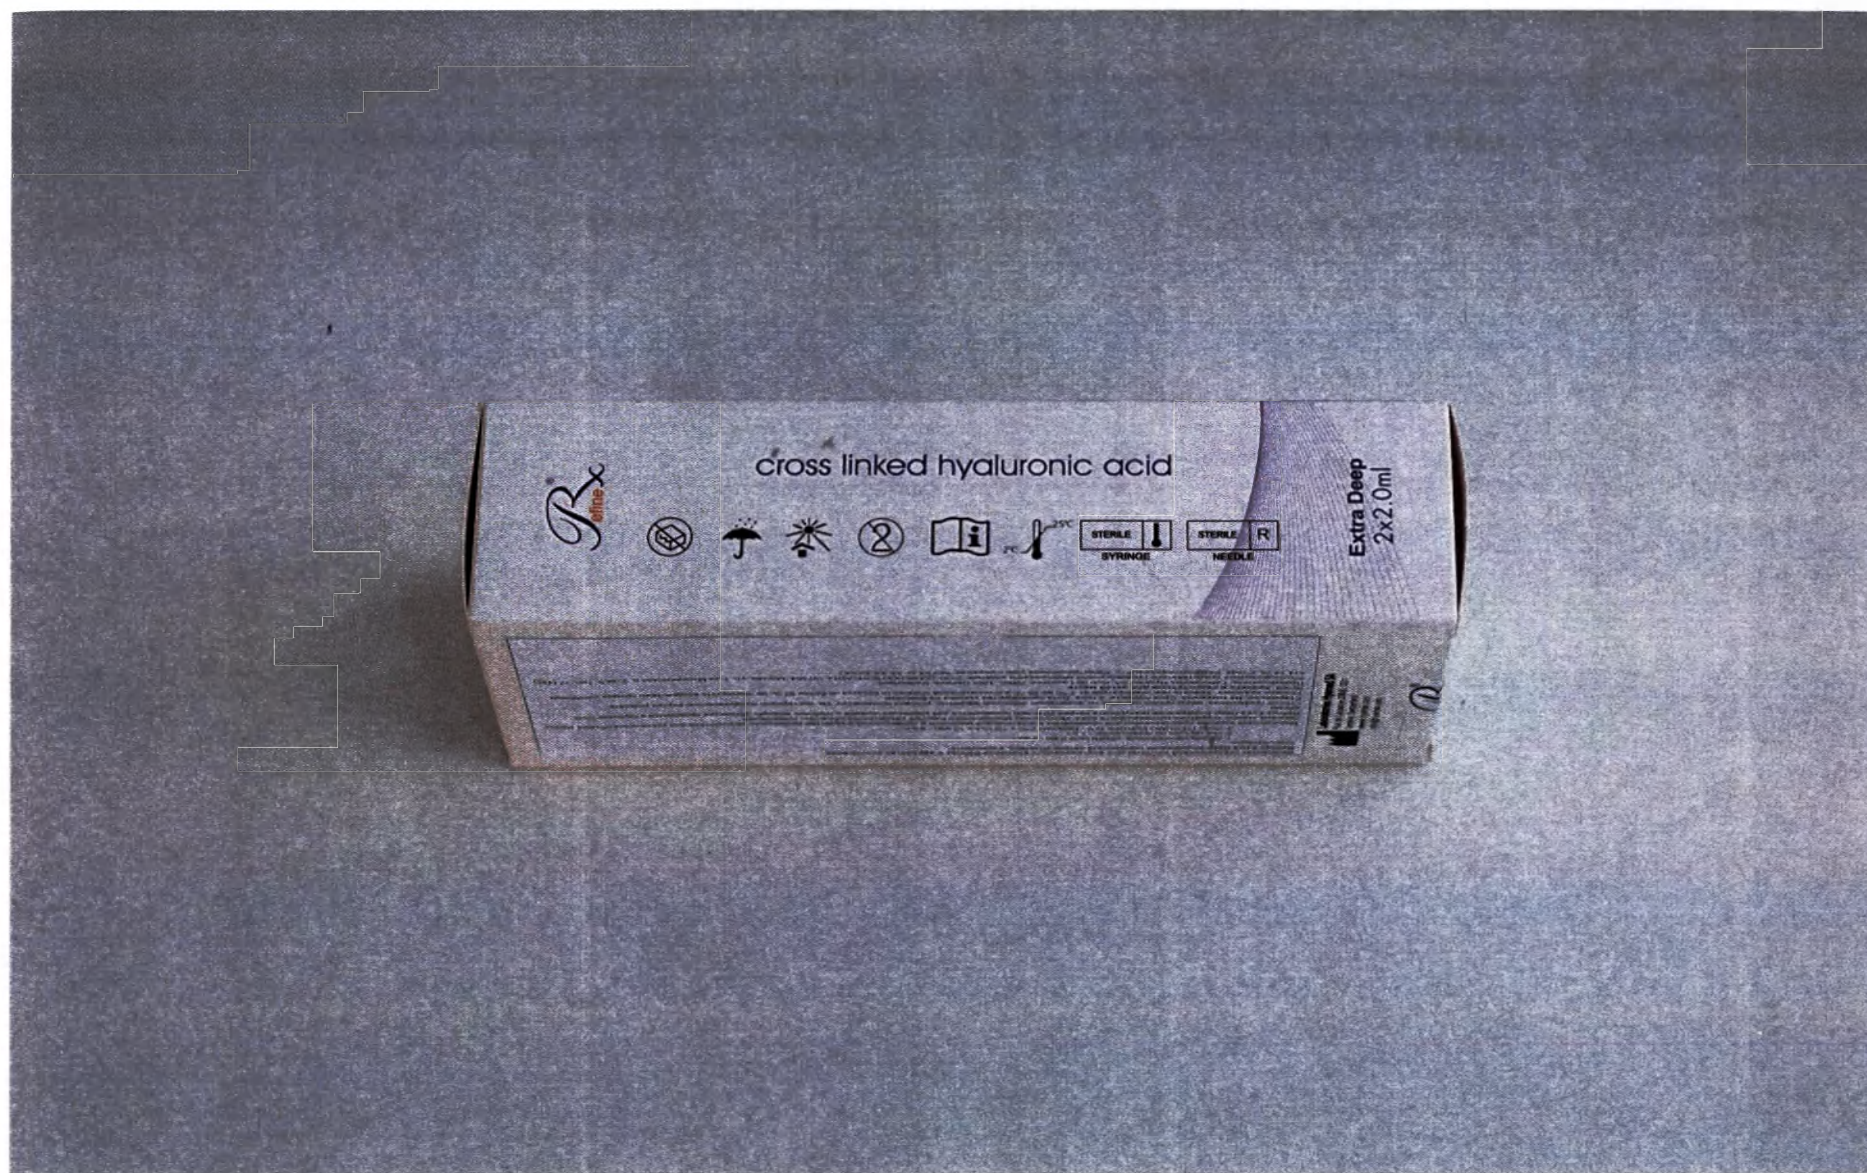


Рис. 8. На фотографии приведен общий вид боковой стороны картонной коробки Refinex Extra Deep



Рис. 9. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны картонной коробки Refinex Deep

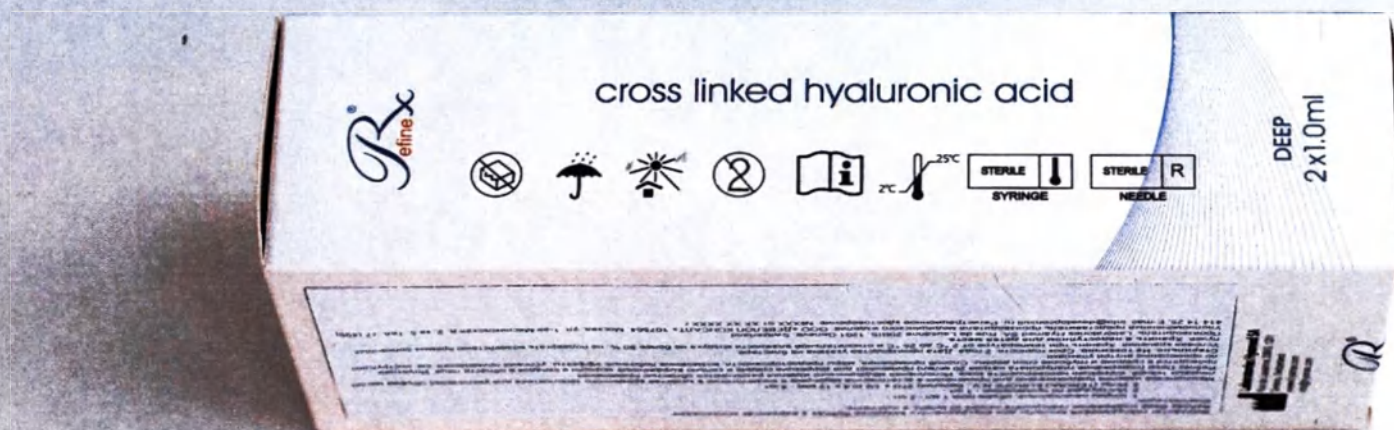


Рис. 10. На фотографии приведен общий вид боковой стороны картонной коробки Refinex Deep



Рис. 11. На фотографии приведен общий вид боковой стороны картонной коробки Refinex Deep

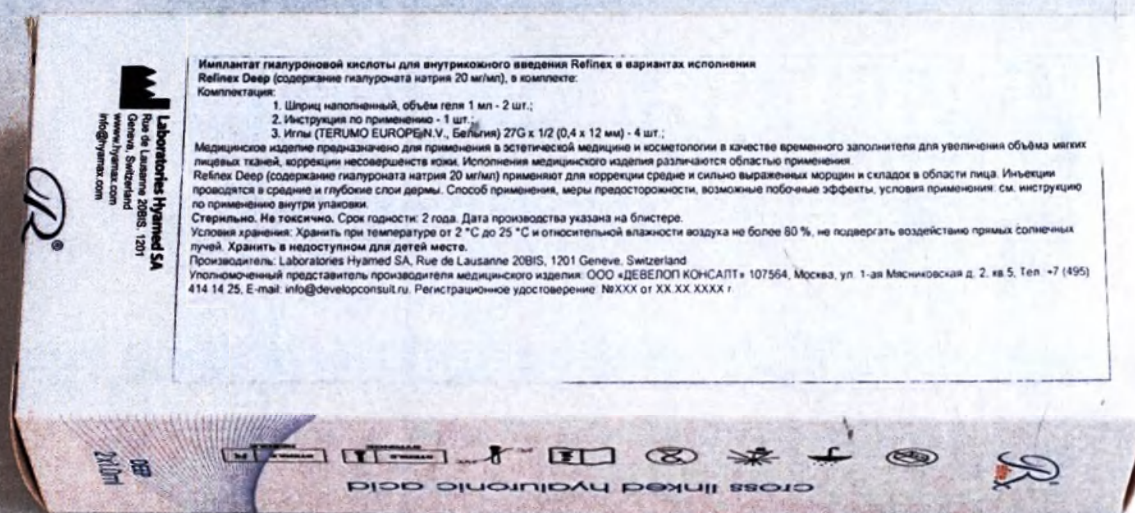


Рис. 12. На фотографии приведен общий вид оборотной стороны картонной коробки Refinex Deer



Рис. 13. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны картонной коробки Refinex Lips

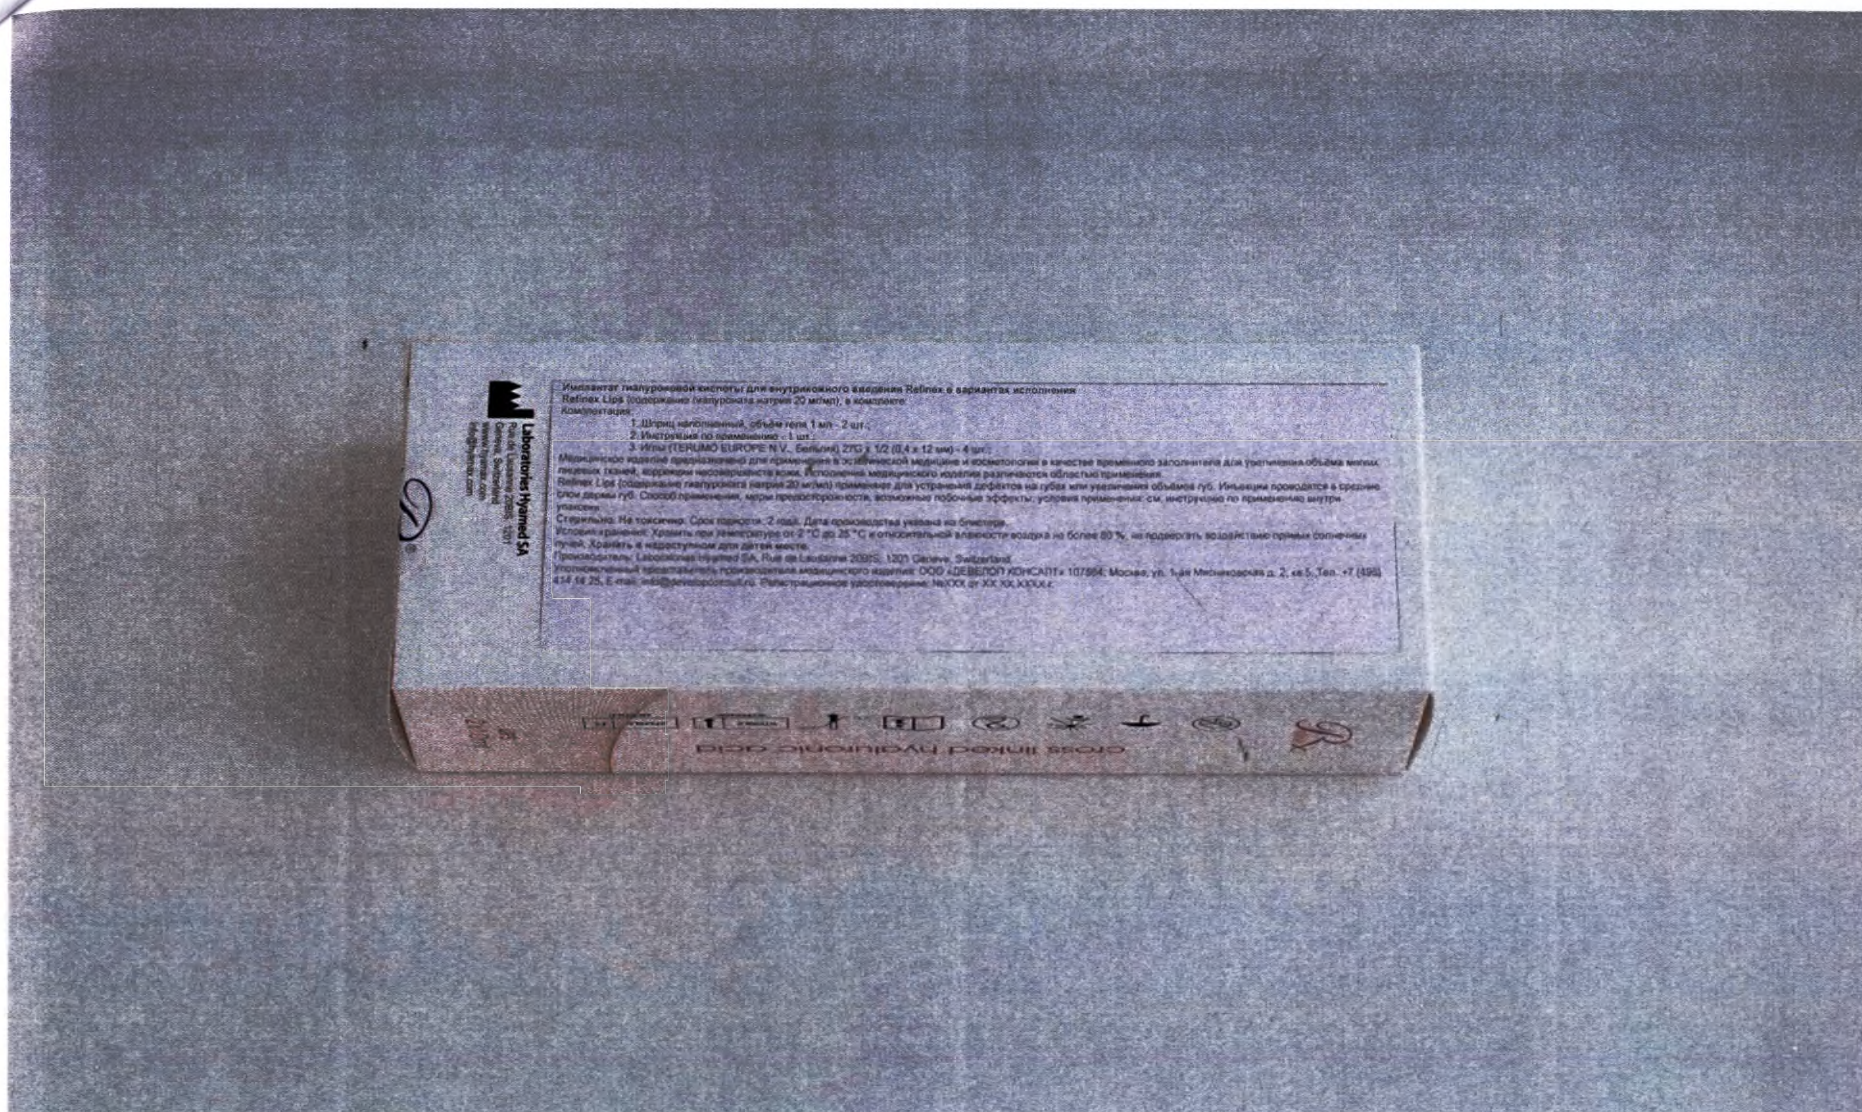


Рис. 14. На фотографии приведен общий вид оборотной стороны картонной коробки Refinex Lips

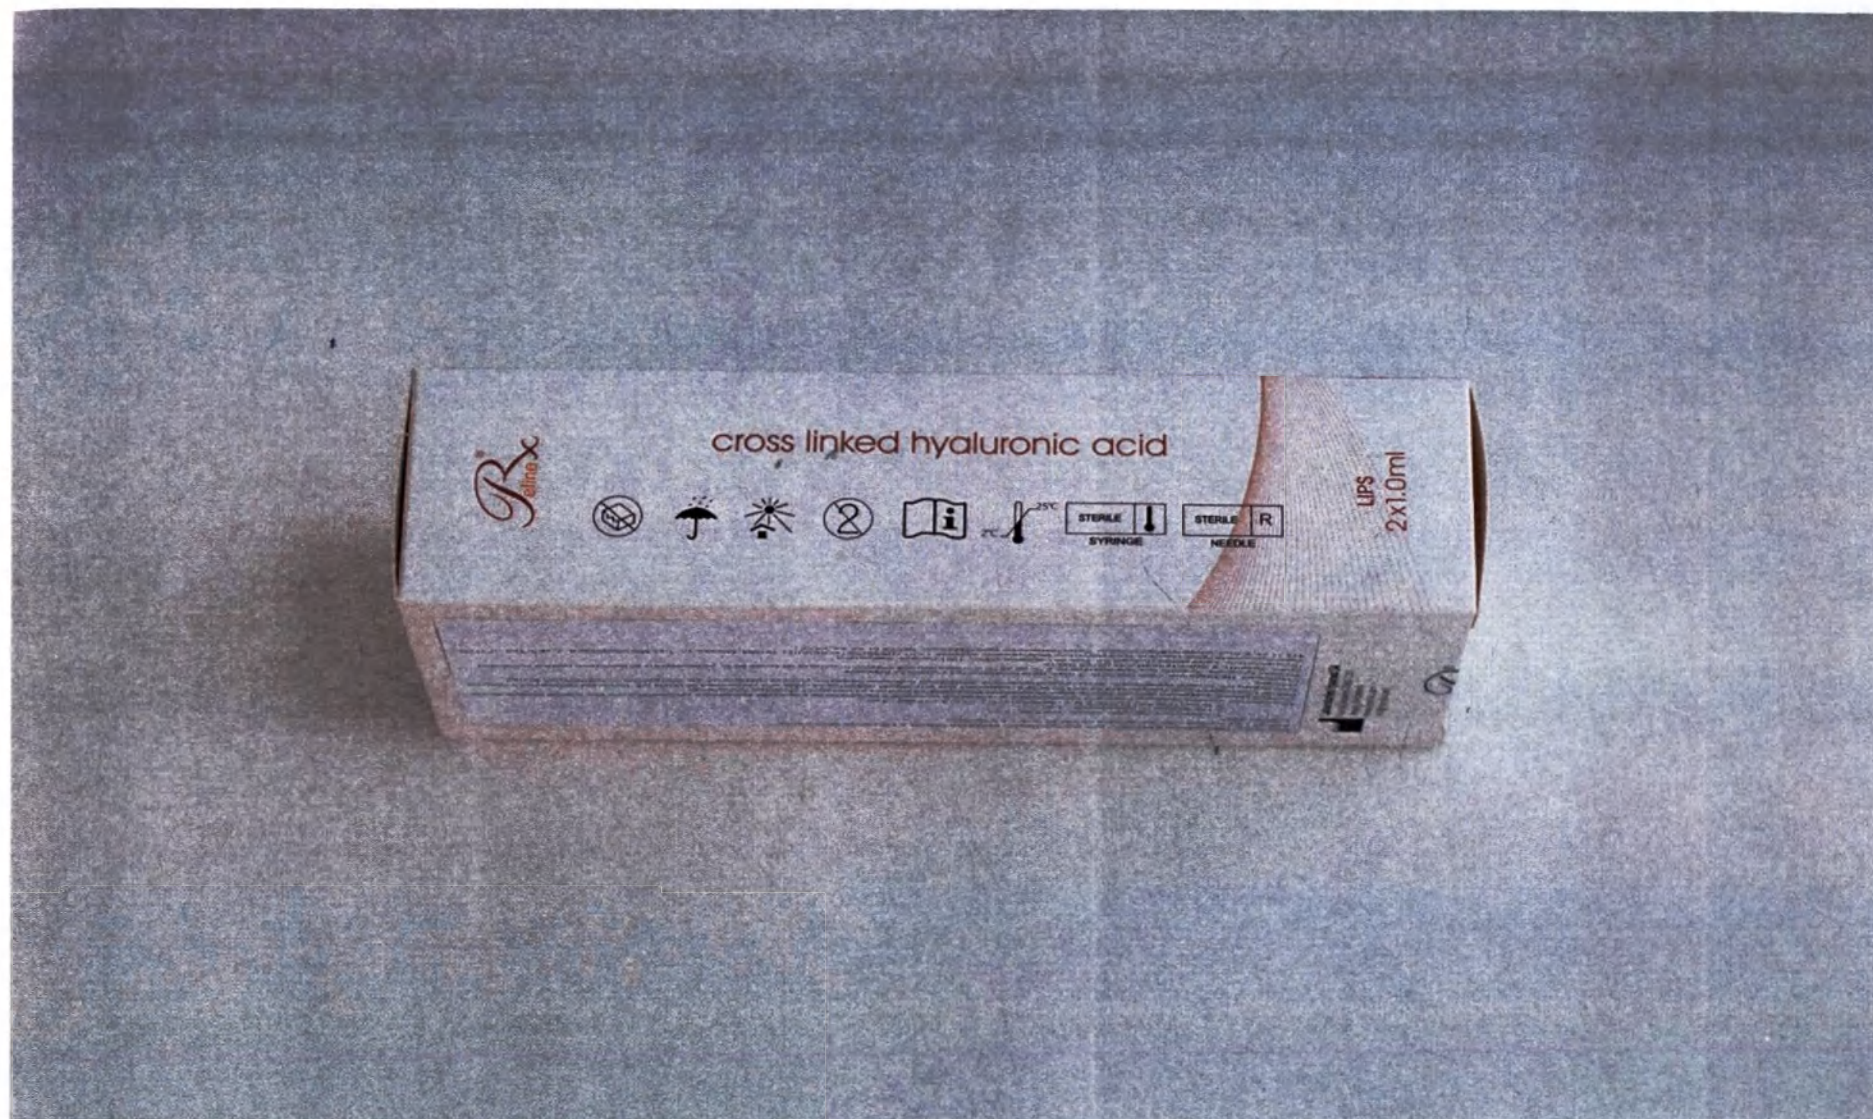


Рис. 15. На фотографии приведен общий вид боковой стороны картонной коробки Refinex Lips

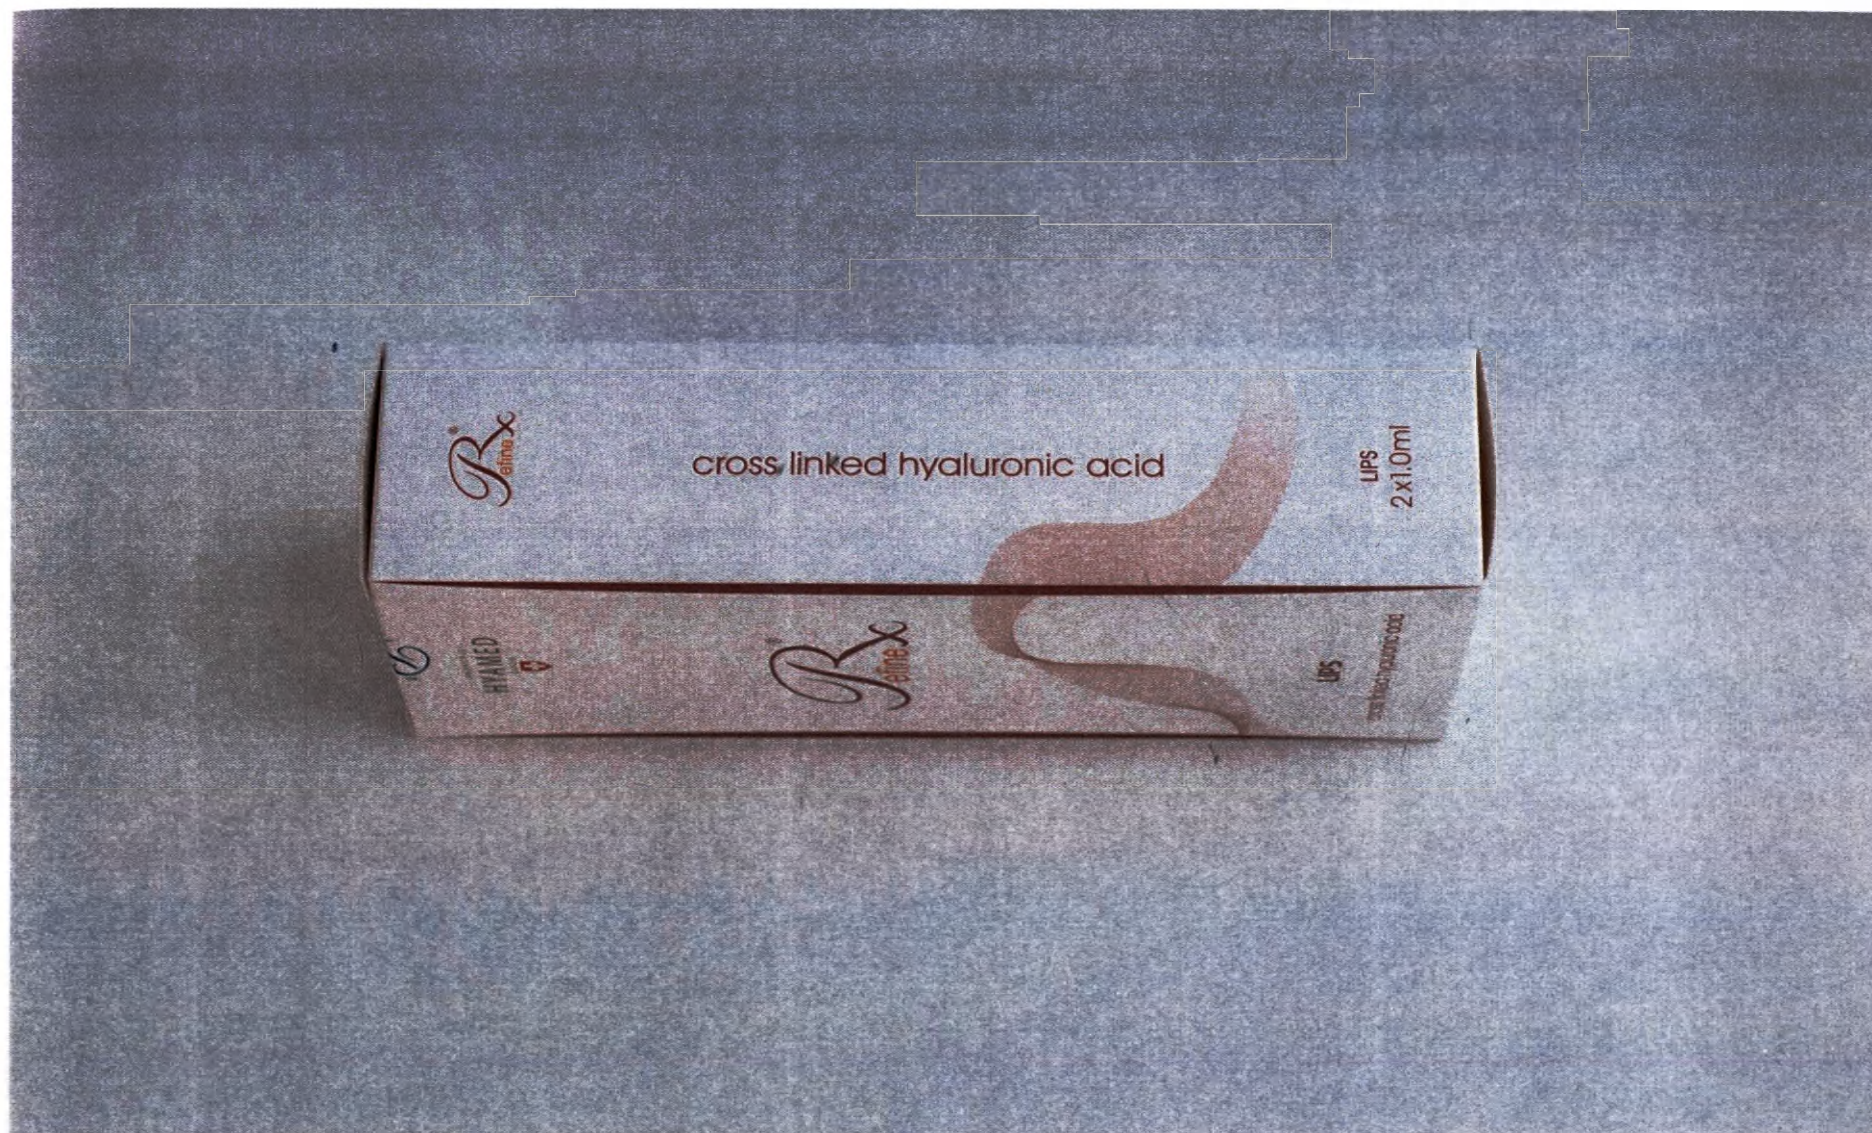


Рис. 16. На фотографии приведен общий вид боковой стороны картонной коробки Refinex Lips



Рис. 17. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны блистера Refinex Lips

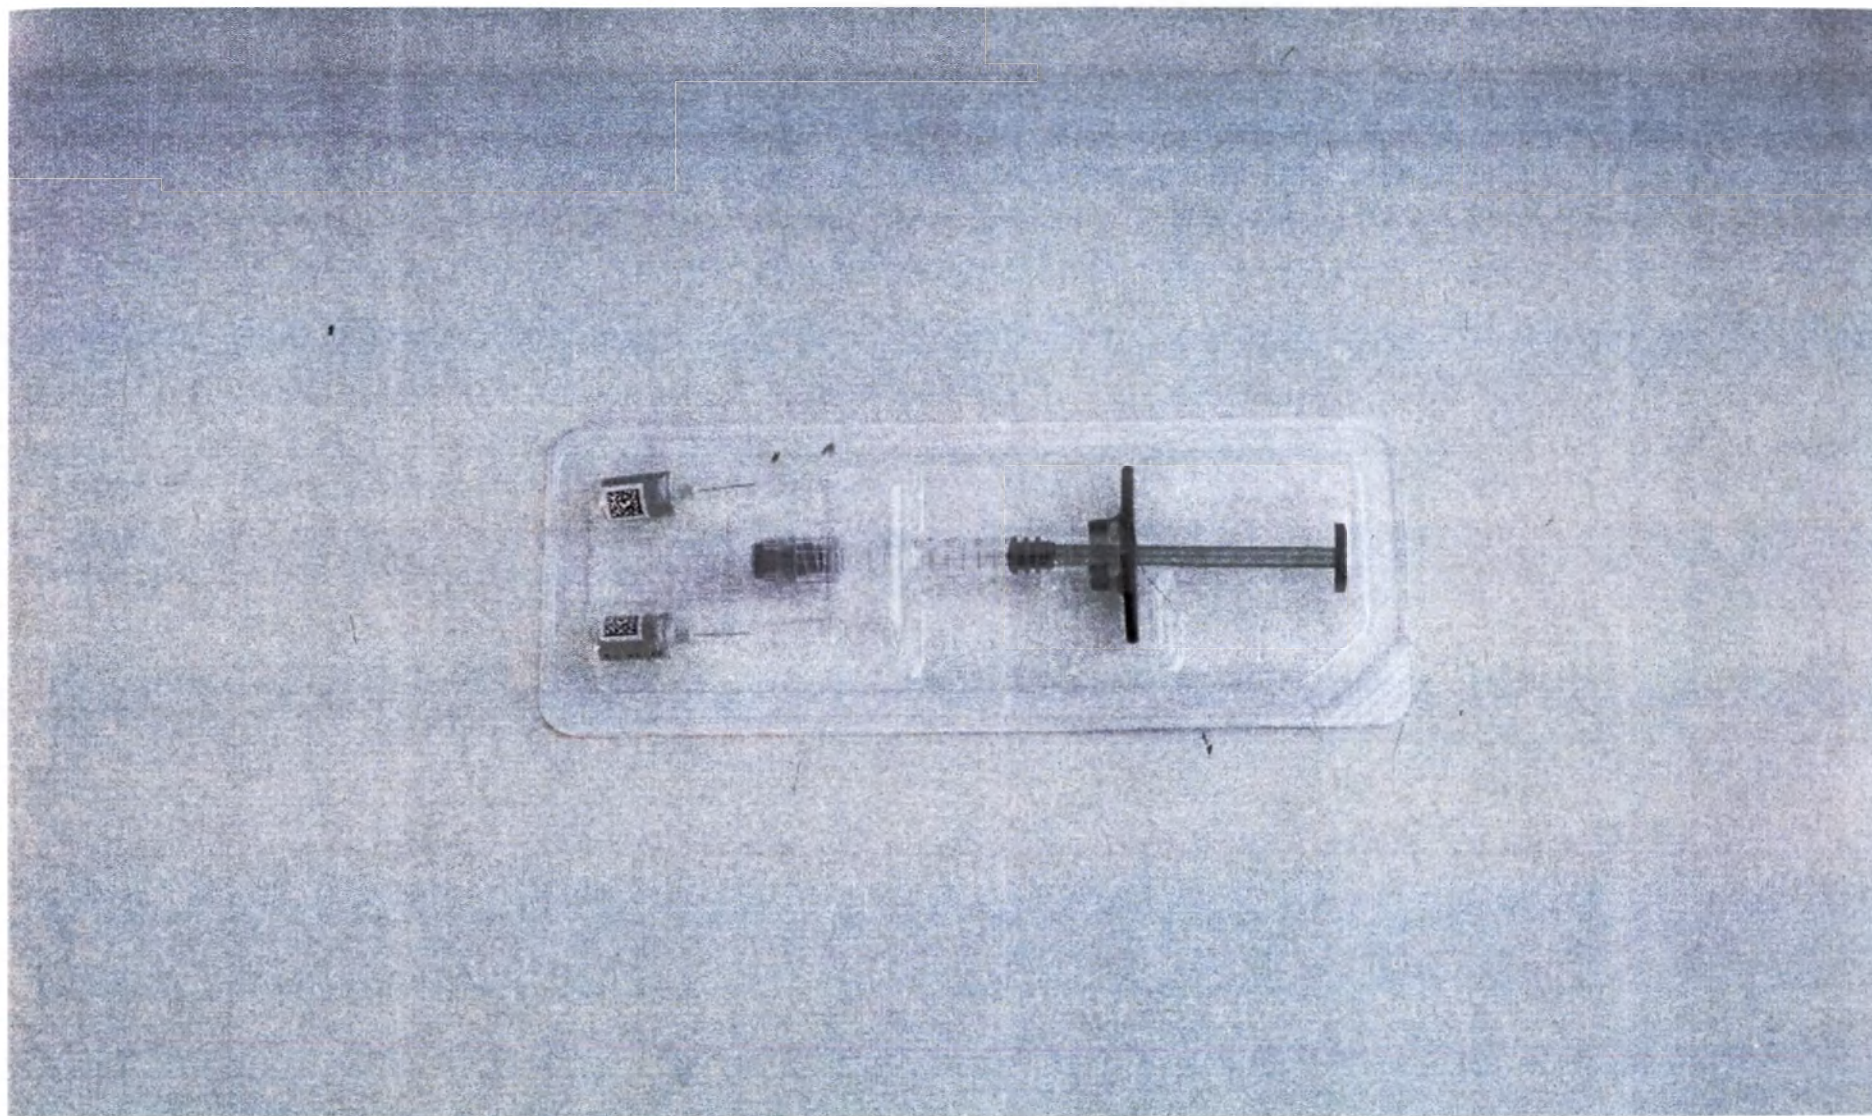


Рис. 18. На фотографии приведен общий вид оборотной стороны блистера Refinex Lips

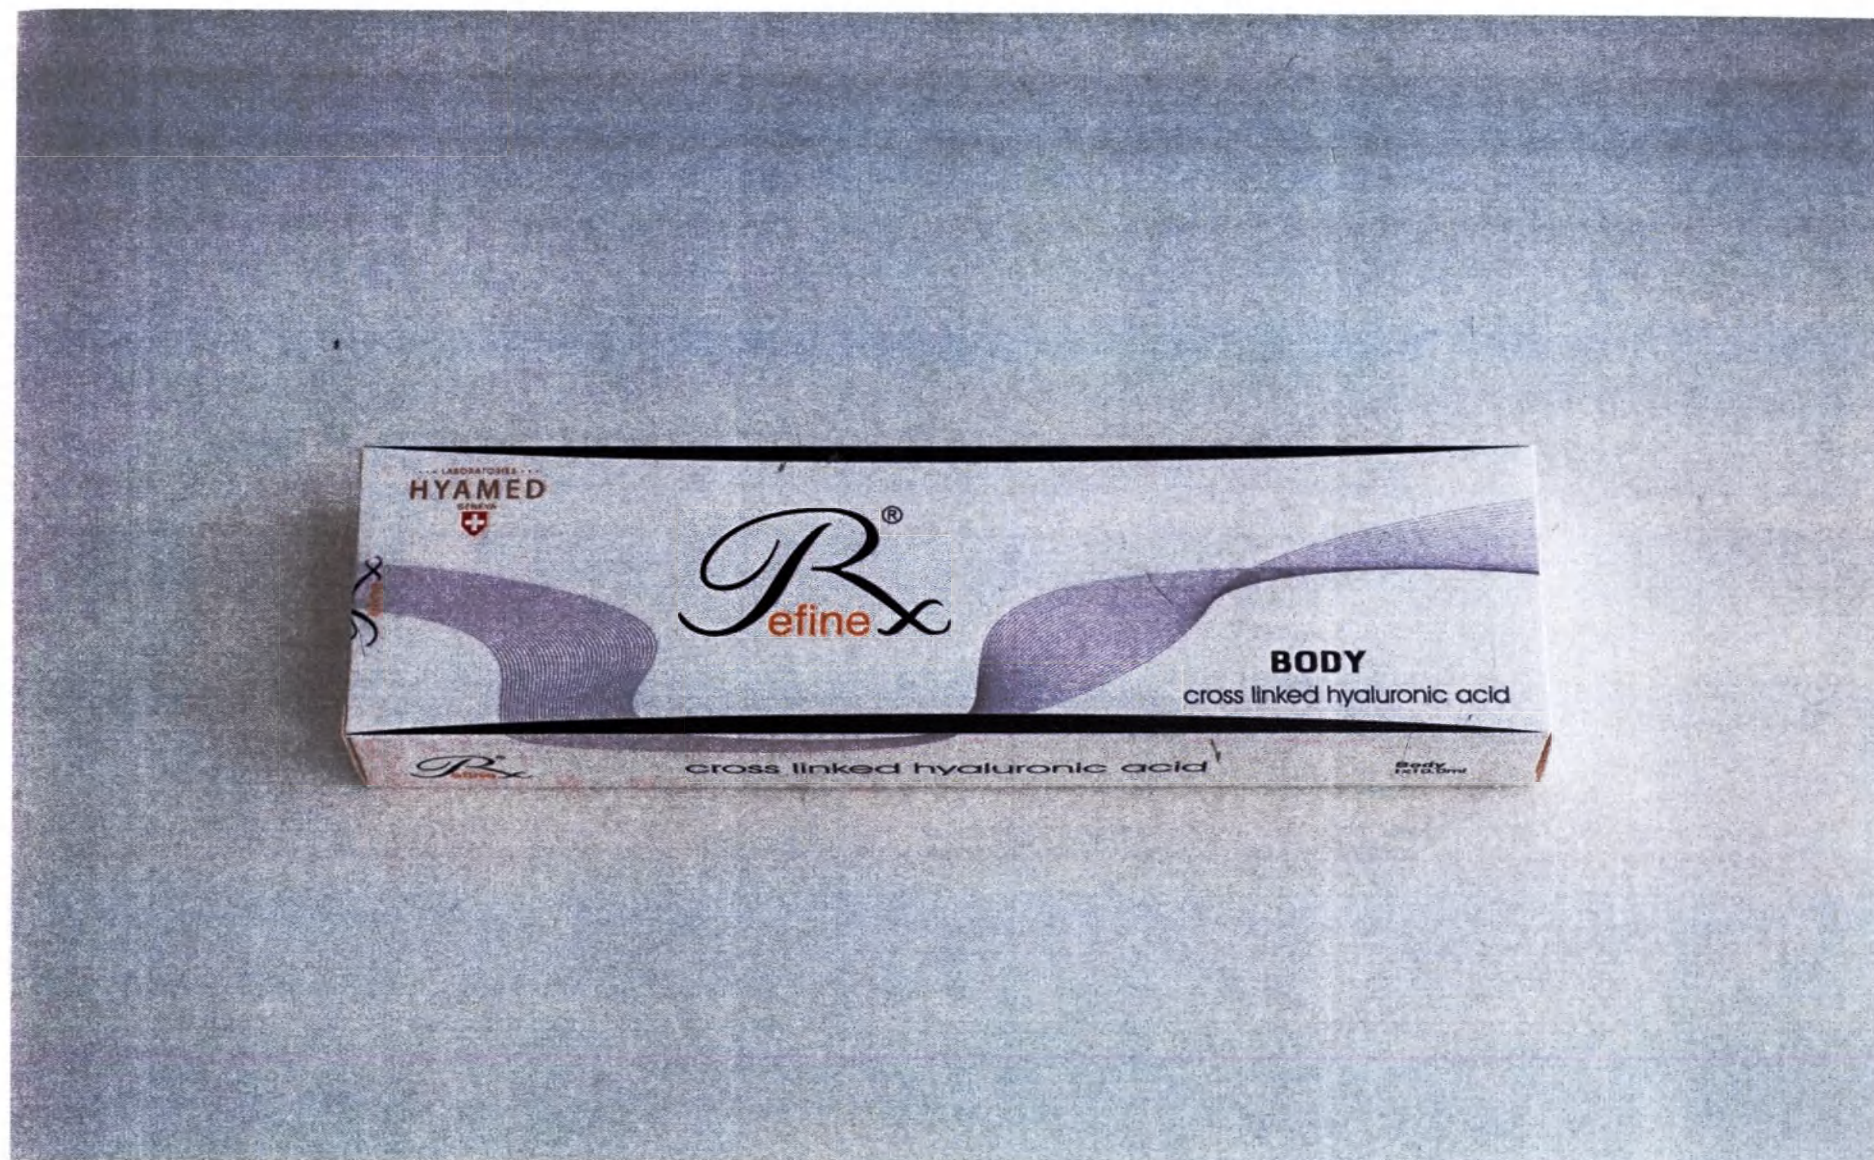


Рис. 19. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны картонной коробки Refinex Body

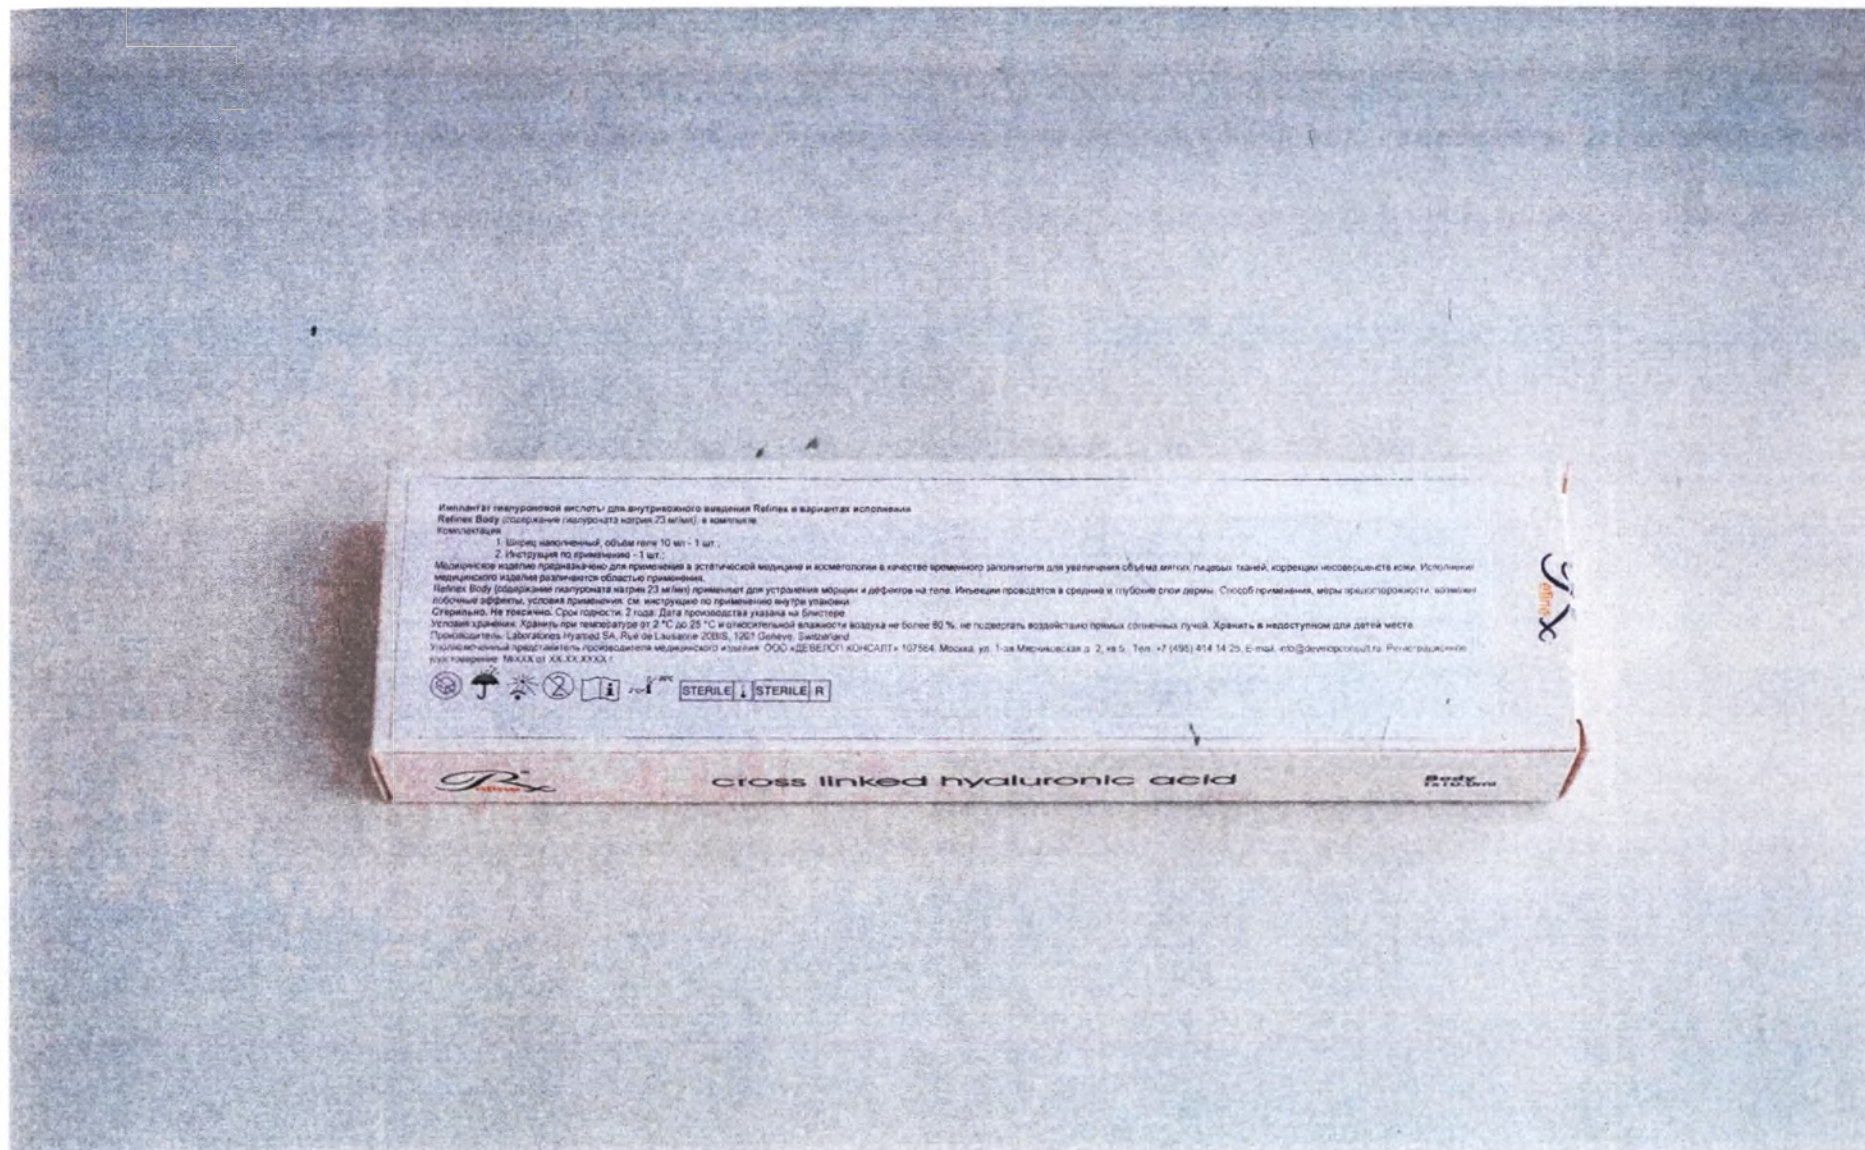


Рис. 20. На фотографии приведен общий вид обратной стороны картонной коробки Refinex Body

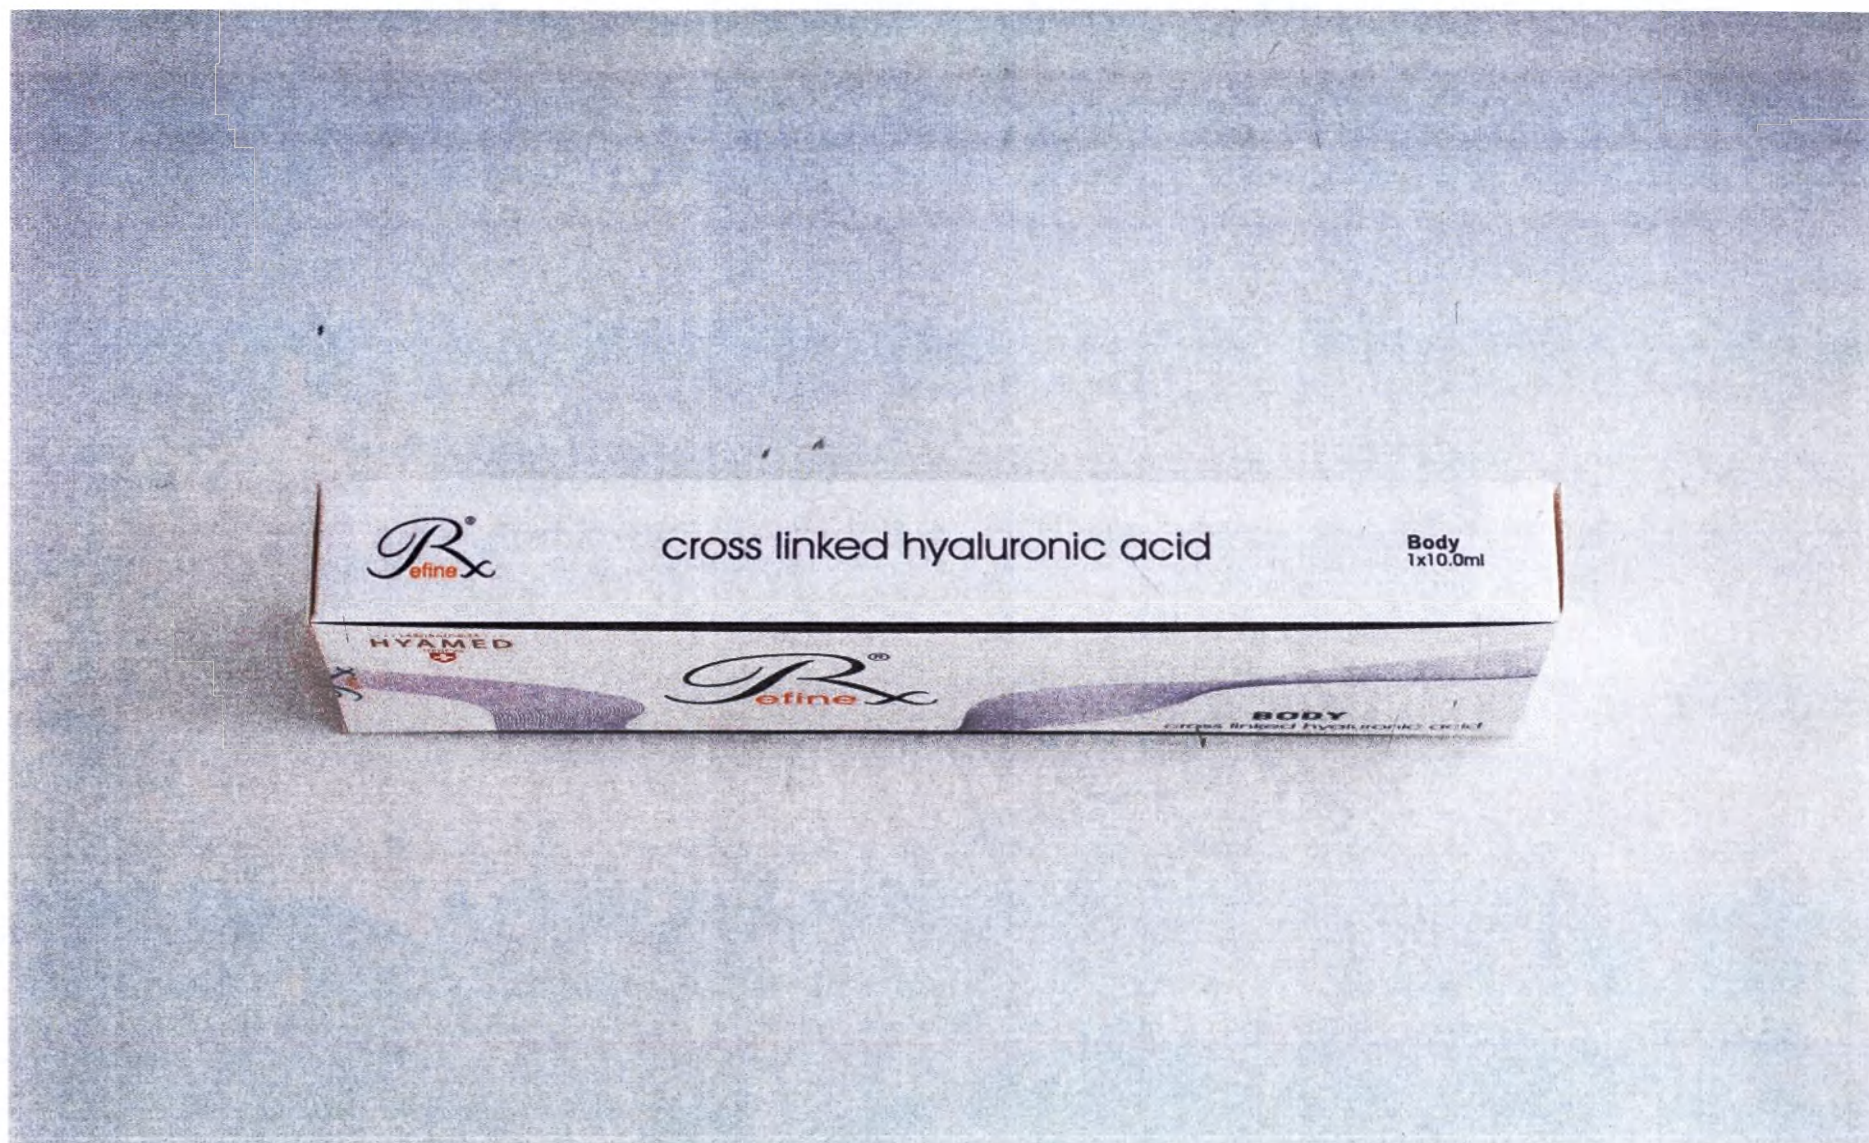


Рис. 21. На фотографии приведен общий вид боковой стороны картонной коробки Refinex Body



Рис. 22. На фотографии приведен общий вид боковой стороны картонной коробки Refinex Body

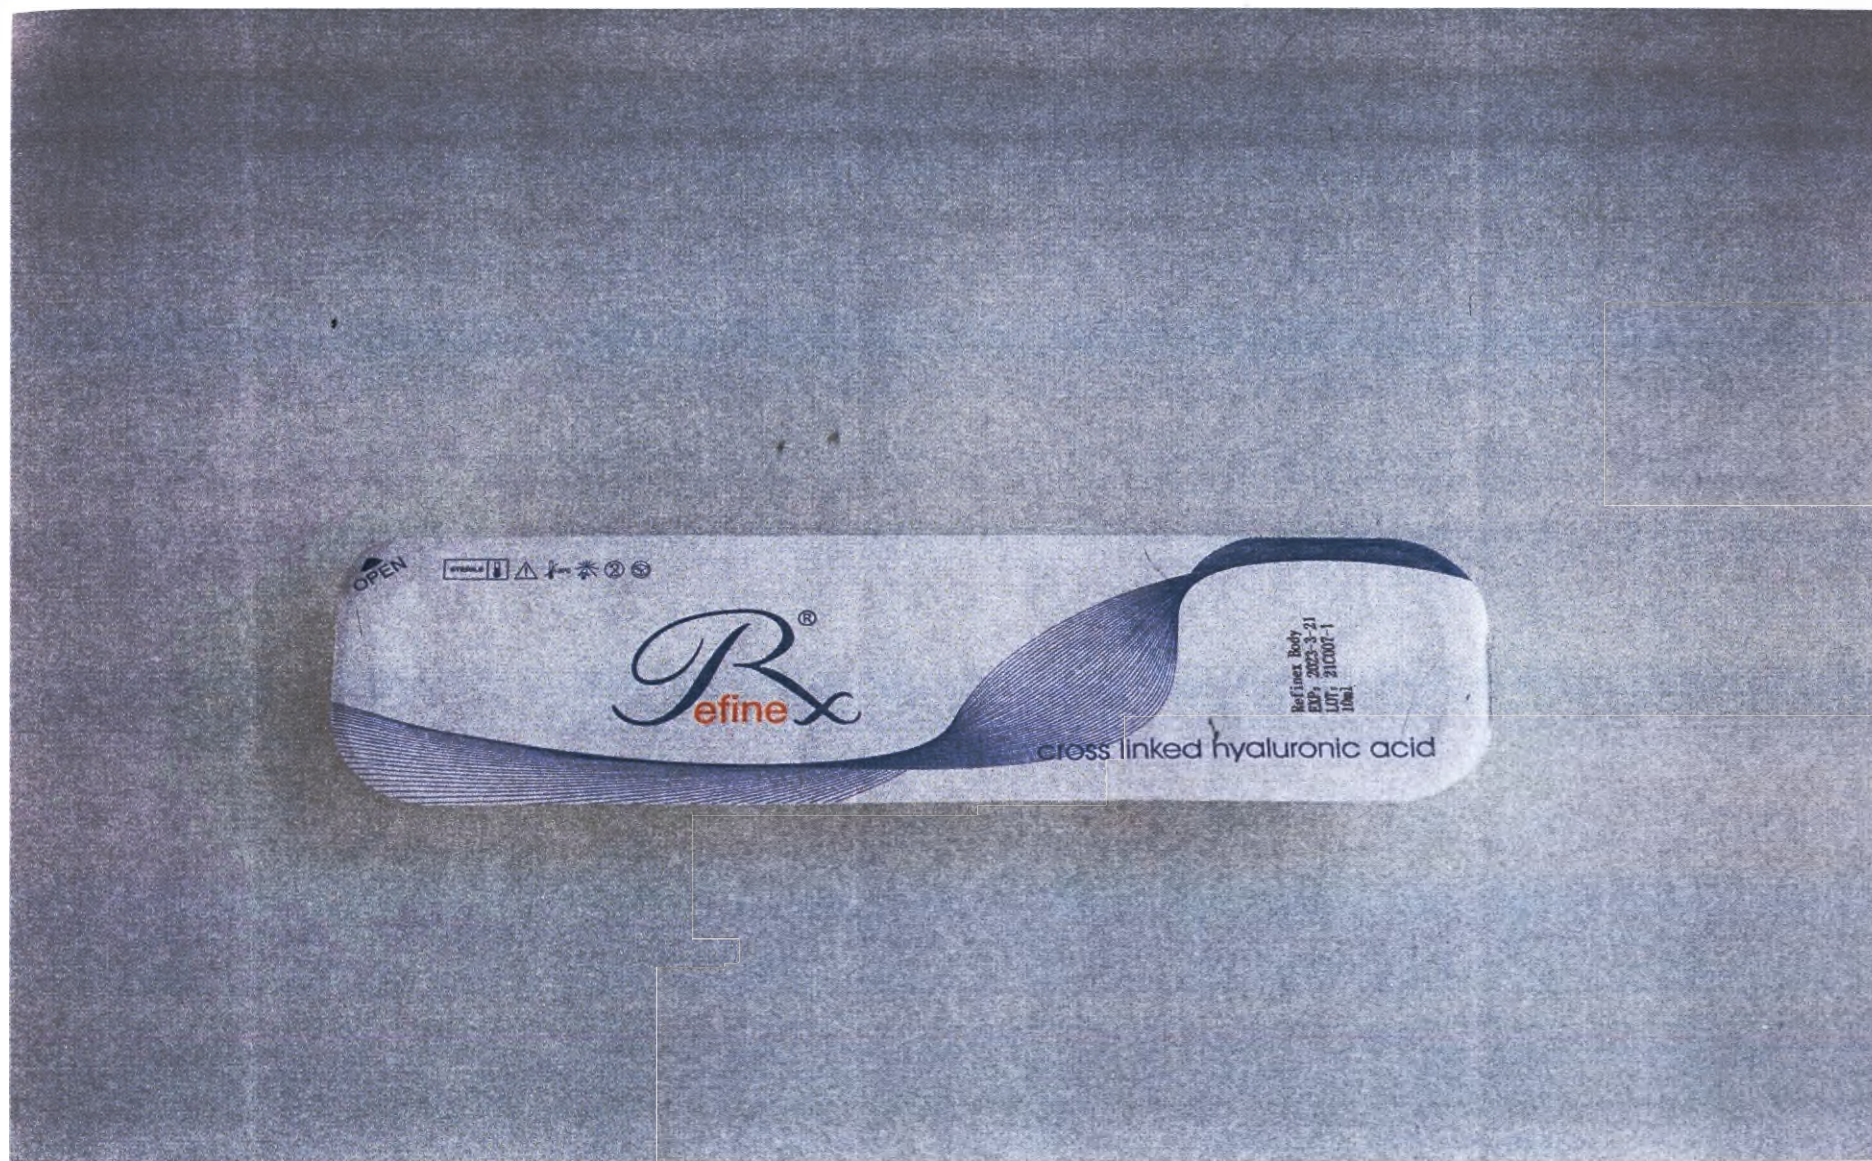


Рис. 23. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны блистера Refinex Body

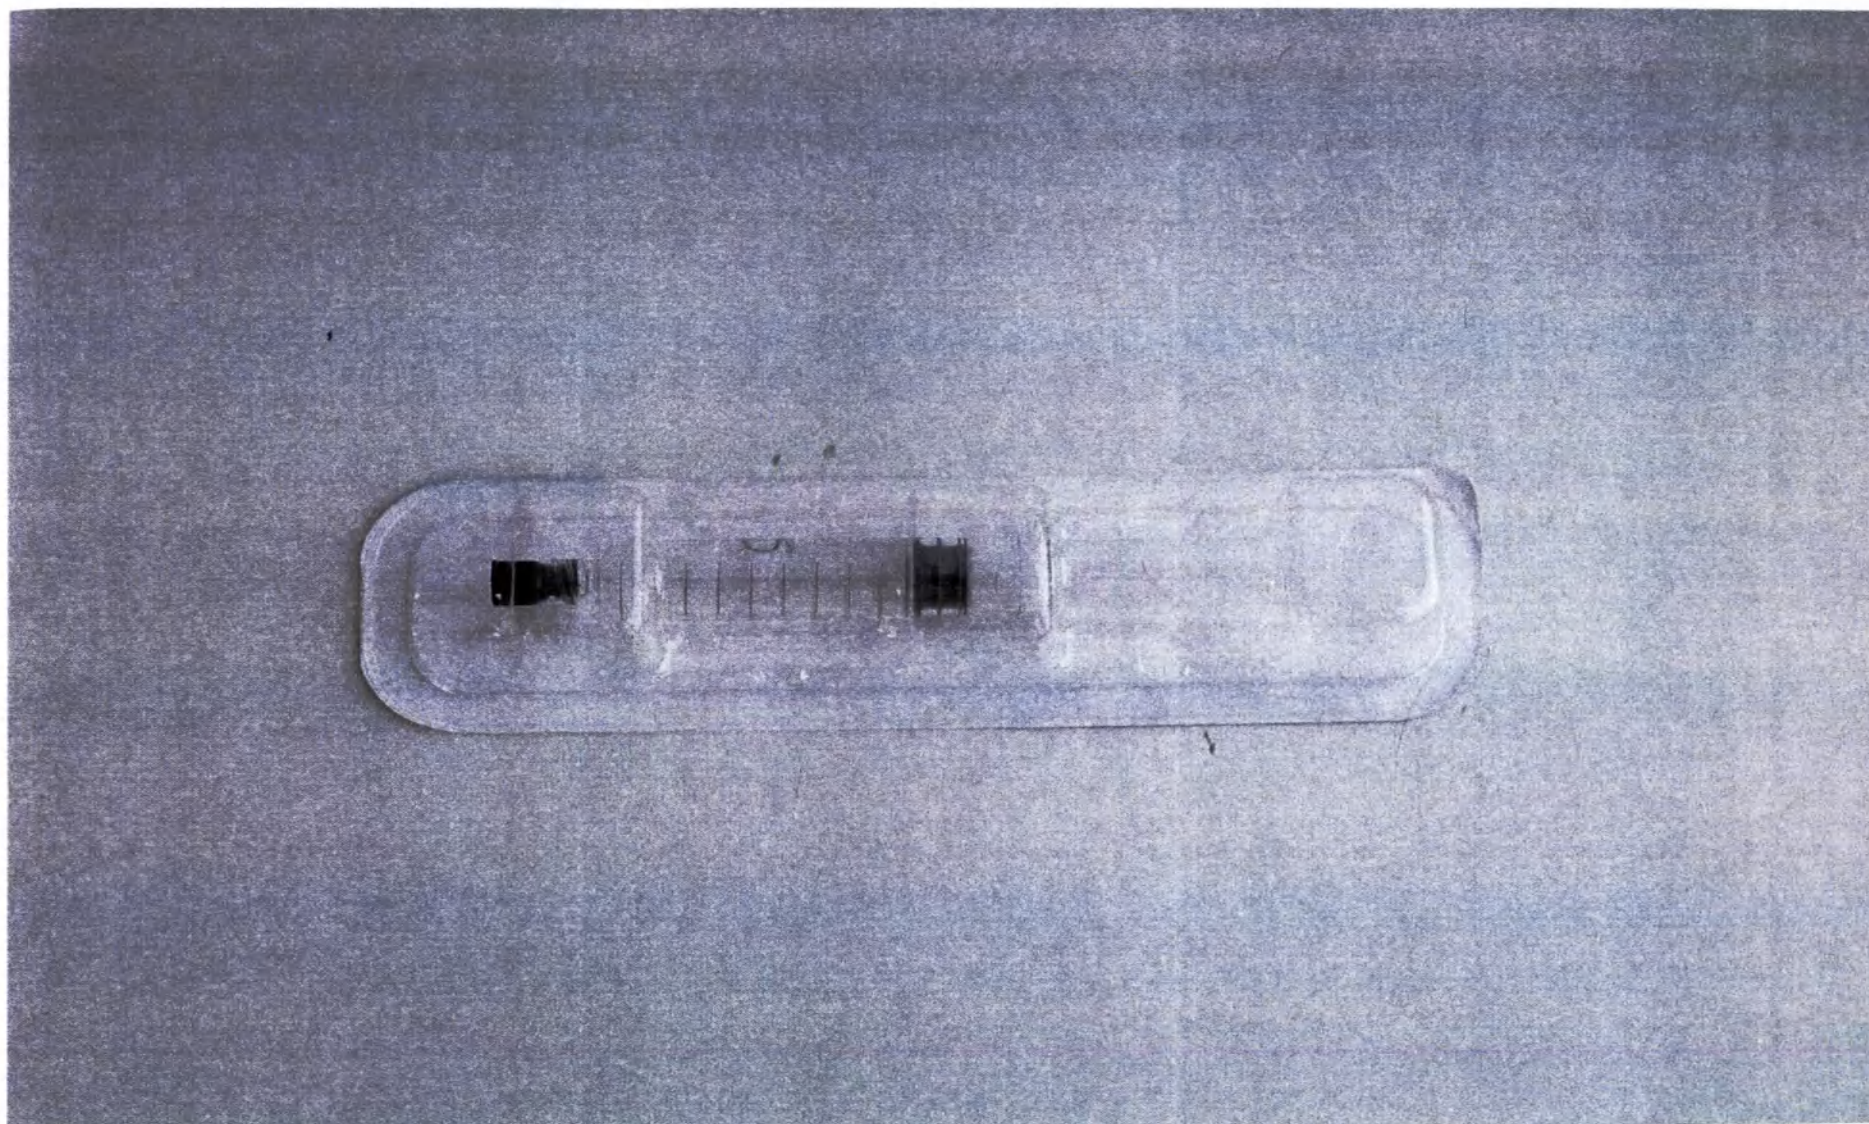


Рис. 24. На фотографии приведен общий вид обратной стороны блистера Refinex Body



Рис. 25. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны картонной коробки Refinex Volume

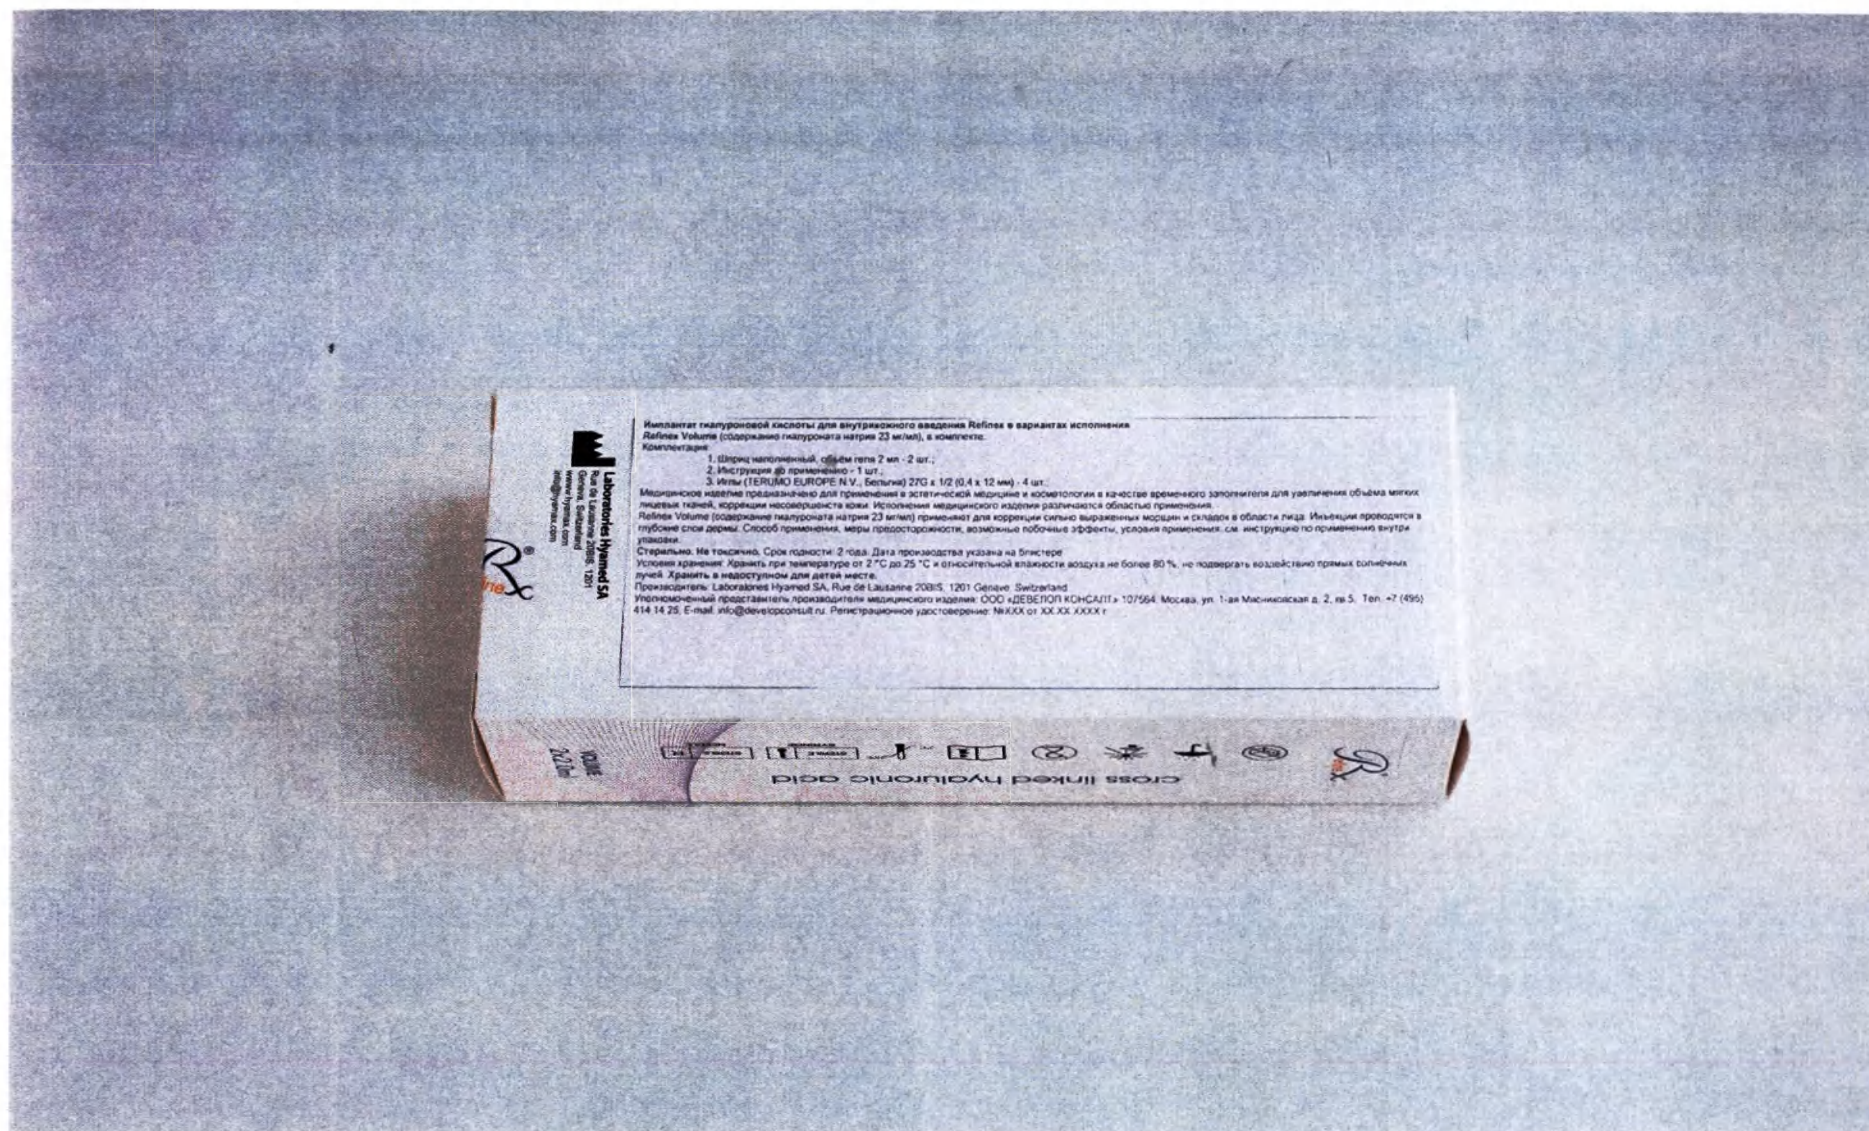


Рис. 26. На фотографии приведен общий вид оборотной стороны картонной коробки Refinex Volume

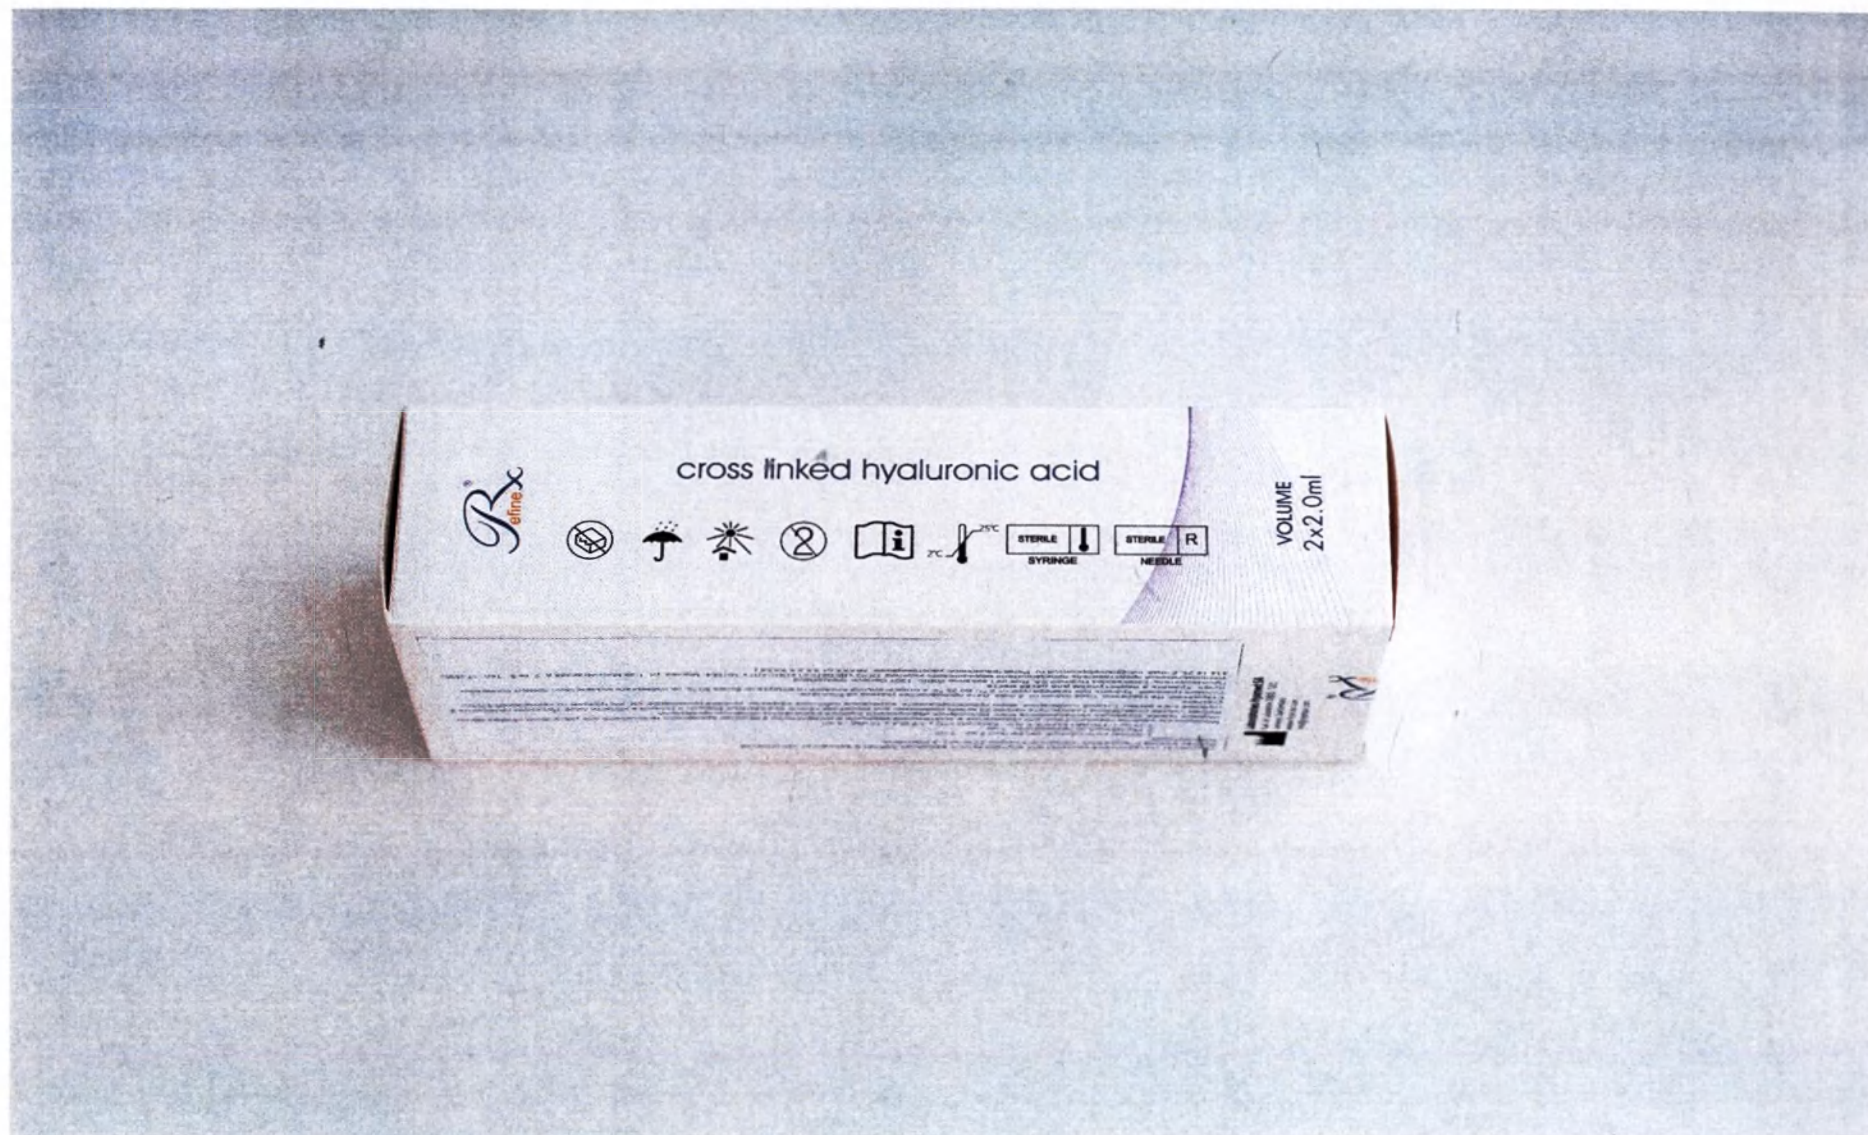


Рис. 27. На фотографии приведен общий вид боковой стороны картонной коробки Refinex Volume



Рис. 28. На фотографии приведен общий вид боковой стороны картонной коробки Refinex Volume



Рис. 29. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны картонной коробки Refinex Volumizer 1.0 ml



Рис. 31. На фотографии приведен общий вид боковой стороны картонной коробки Refinex Volumizer 1.0 ml

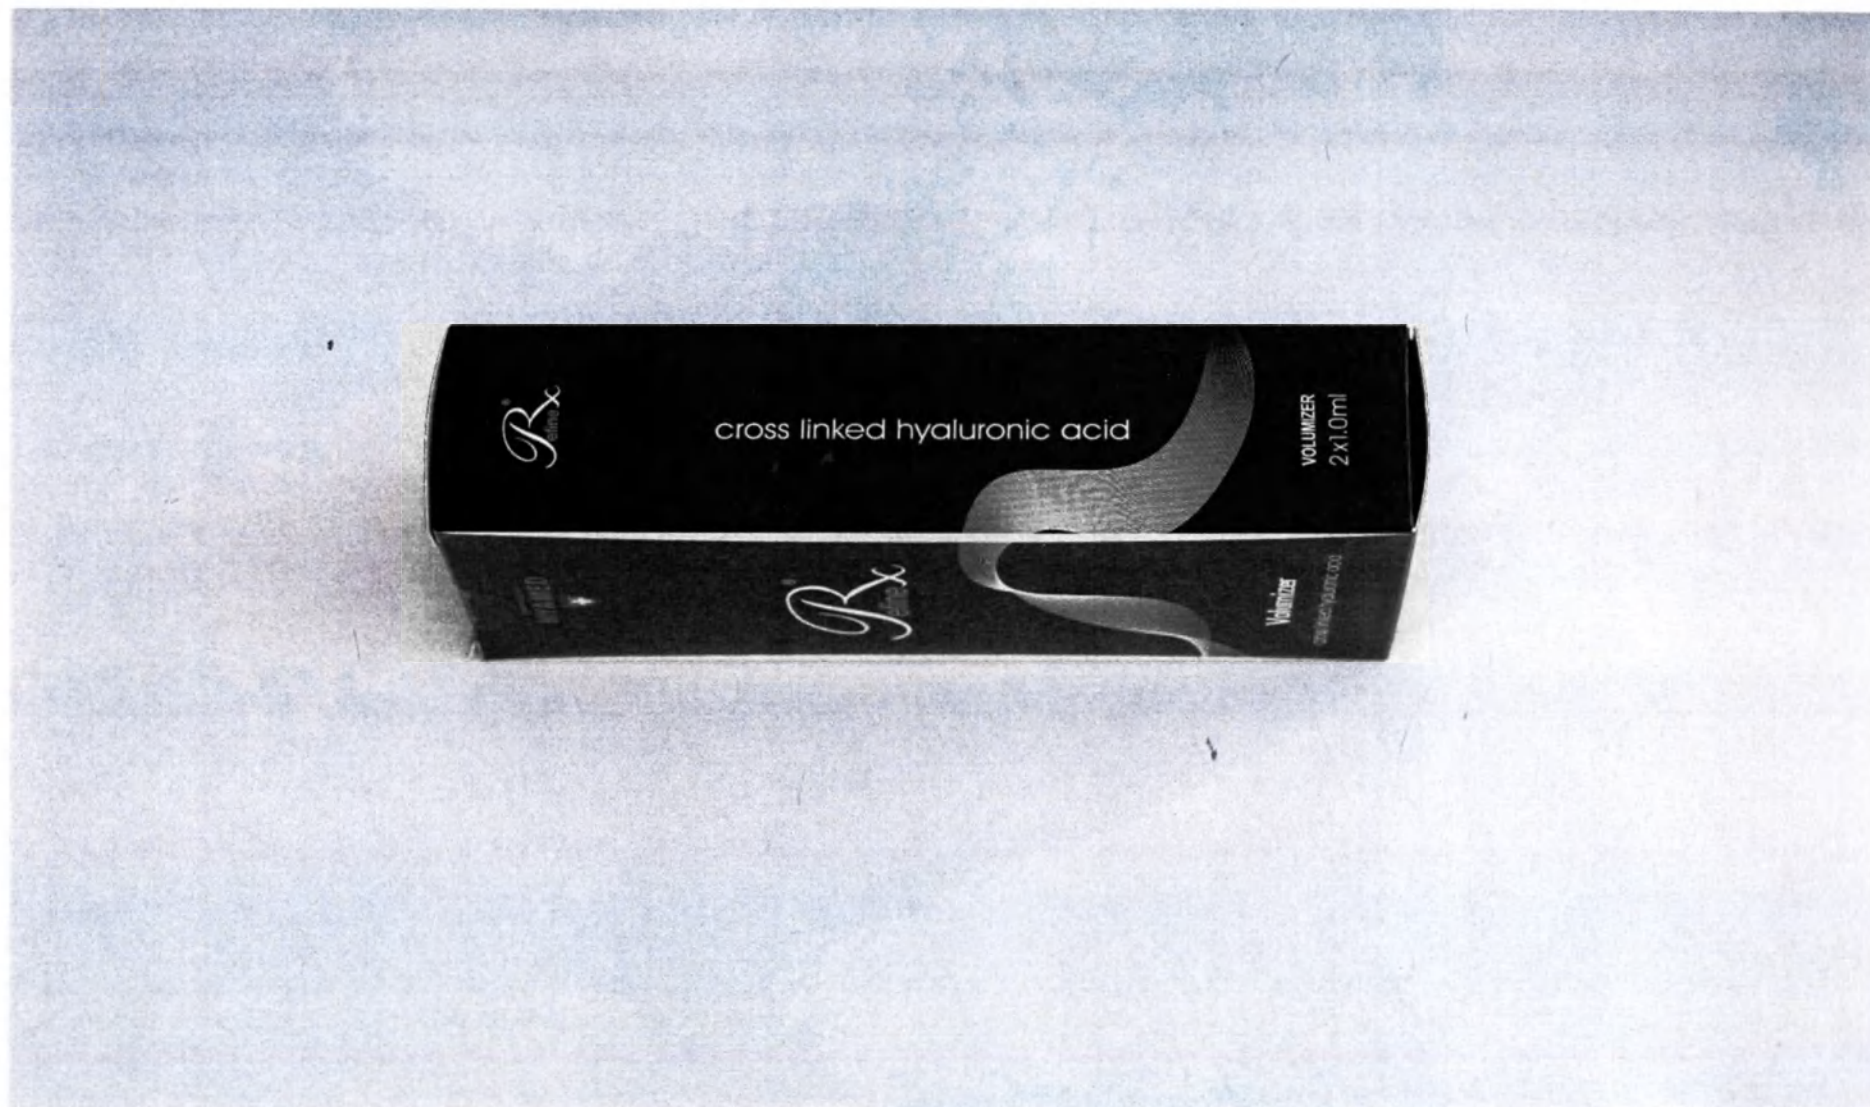


Рис. 32. На фотографии приведен общий вид боковой стороны картонной коробки Refinex Volumizer 1.0 ml

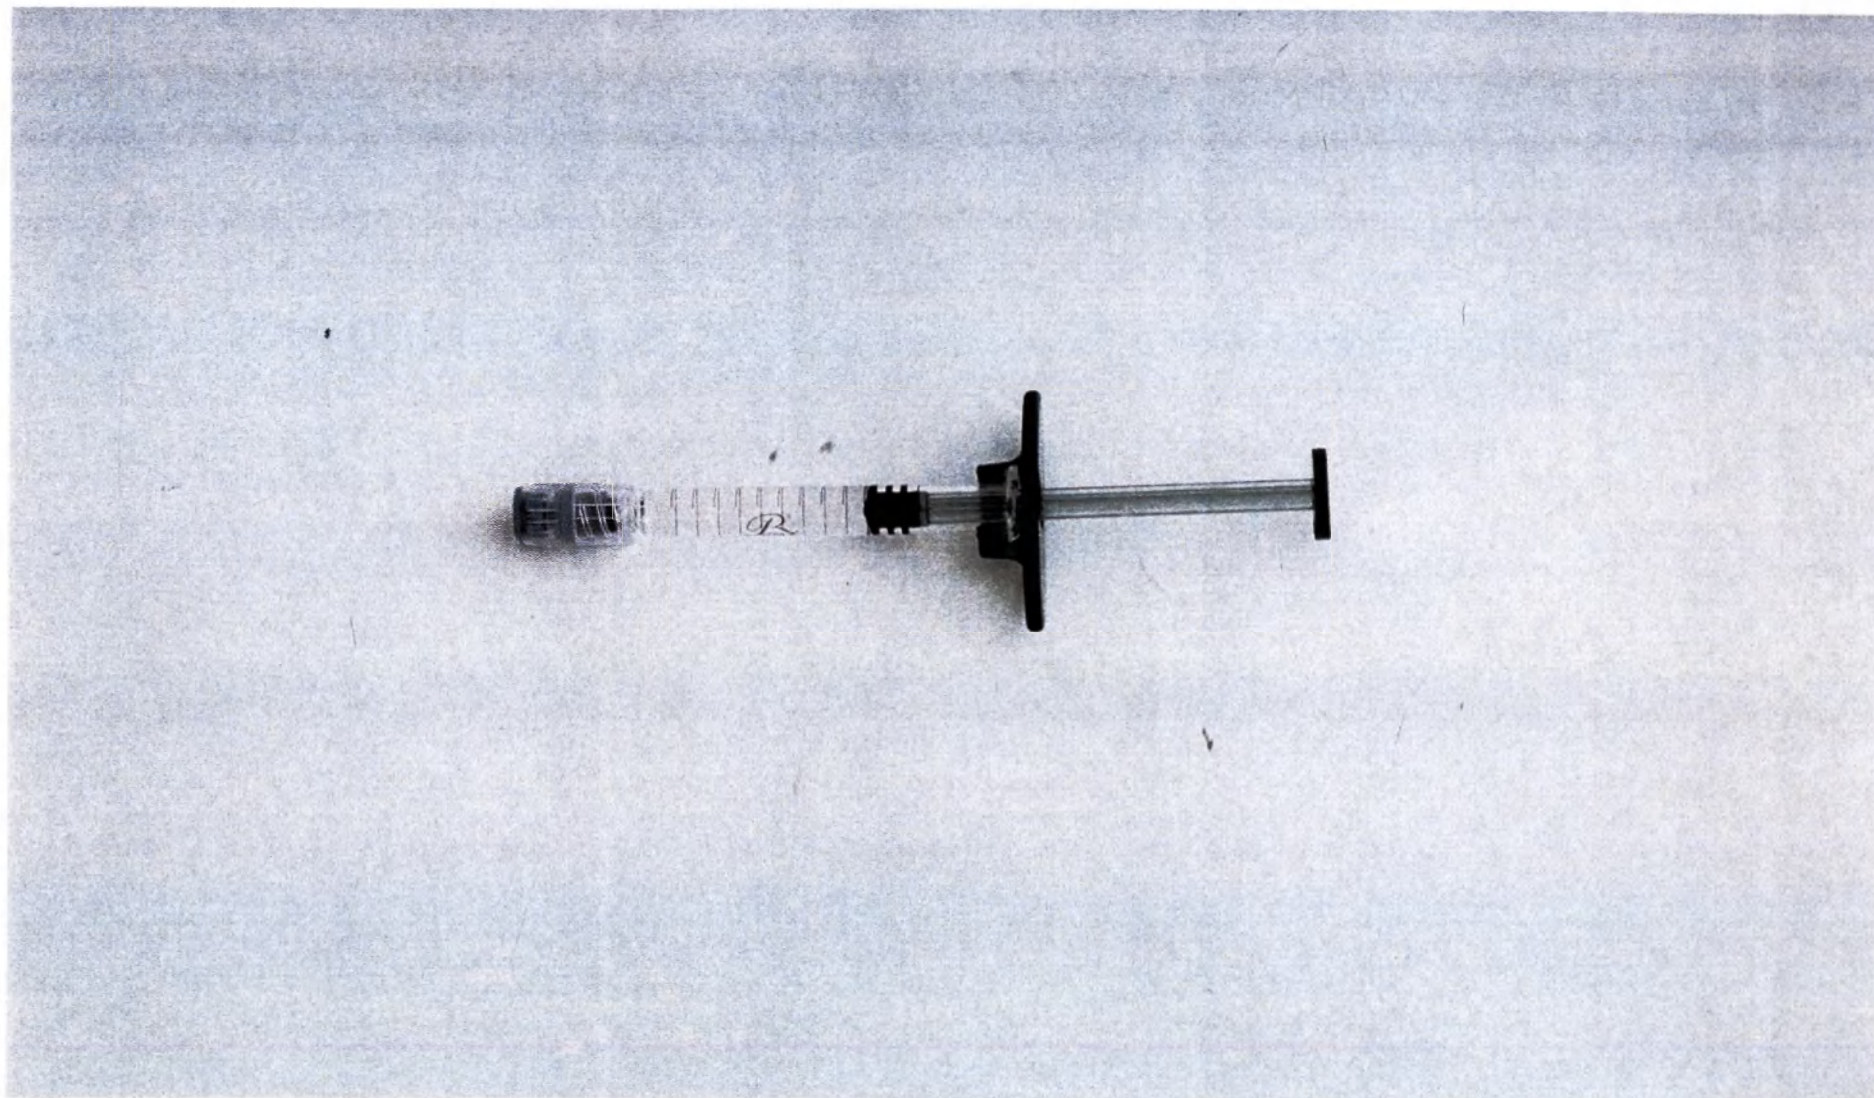


Рис. 33. На фотографии приведен общий вид наполненного шприца Refinex Volumizer 1.0 ml



Рис. 34. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны картонной коробки Refinex Volumizer 2.0 ml

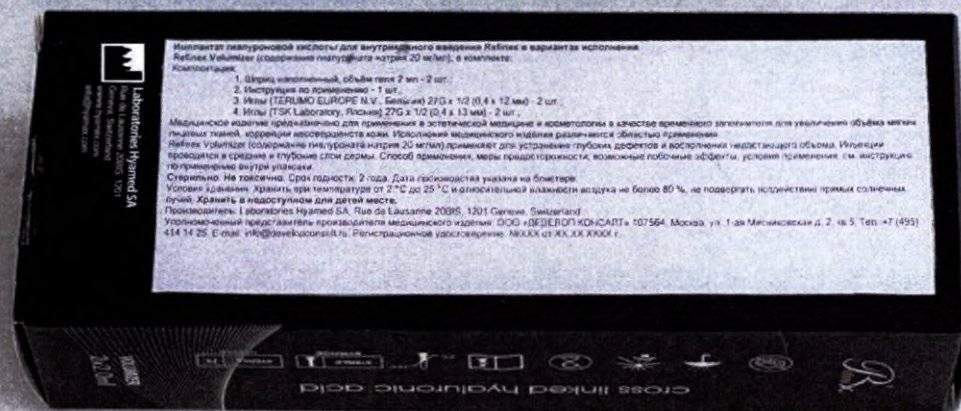


Рис. 35. На фотографии приведен общий вид оборотной стороны картонной коробки Refinex Volumizer 2.0 ml



Рис. 36. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны блистера Refinex Volumizer 2.0 ml

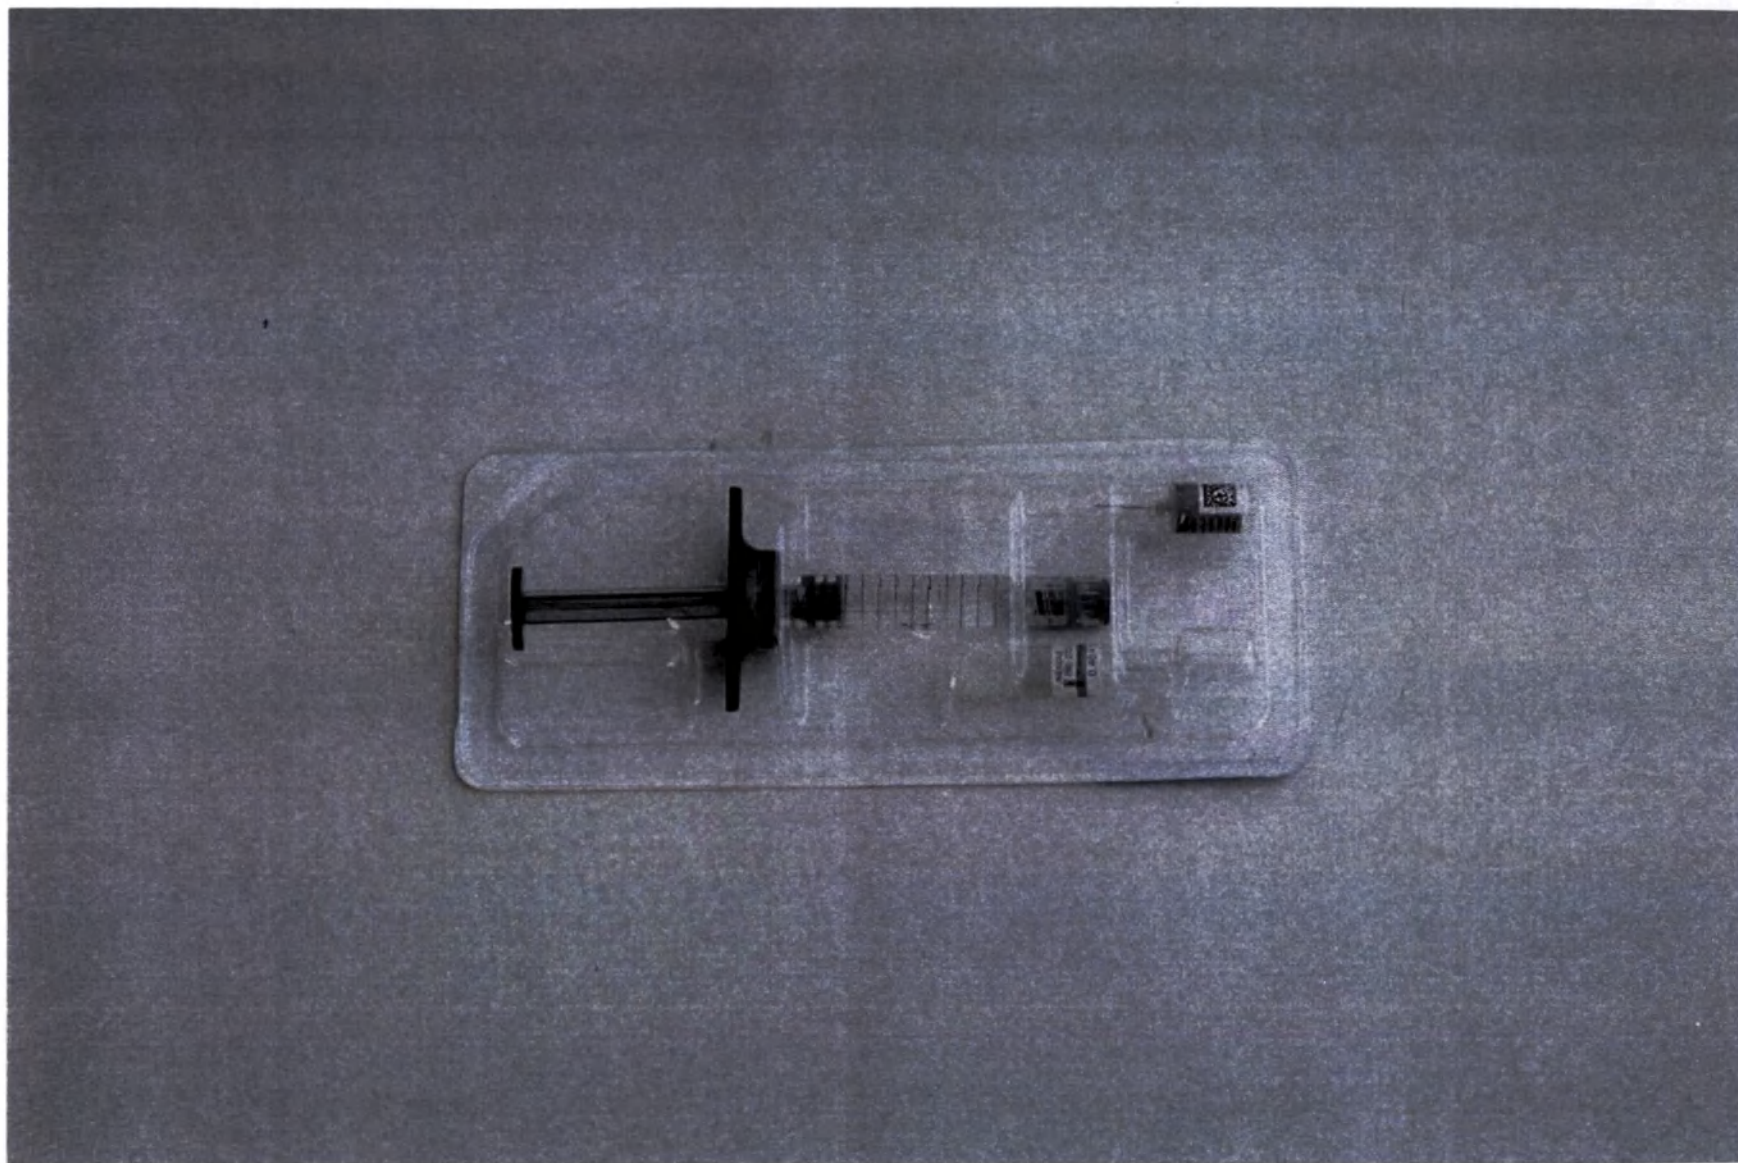


Рис. 37. На фотографии приведен общий вид обратной стороны блистера Refinex Volumizer 2.0 ml

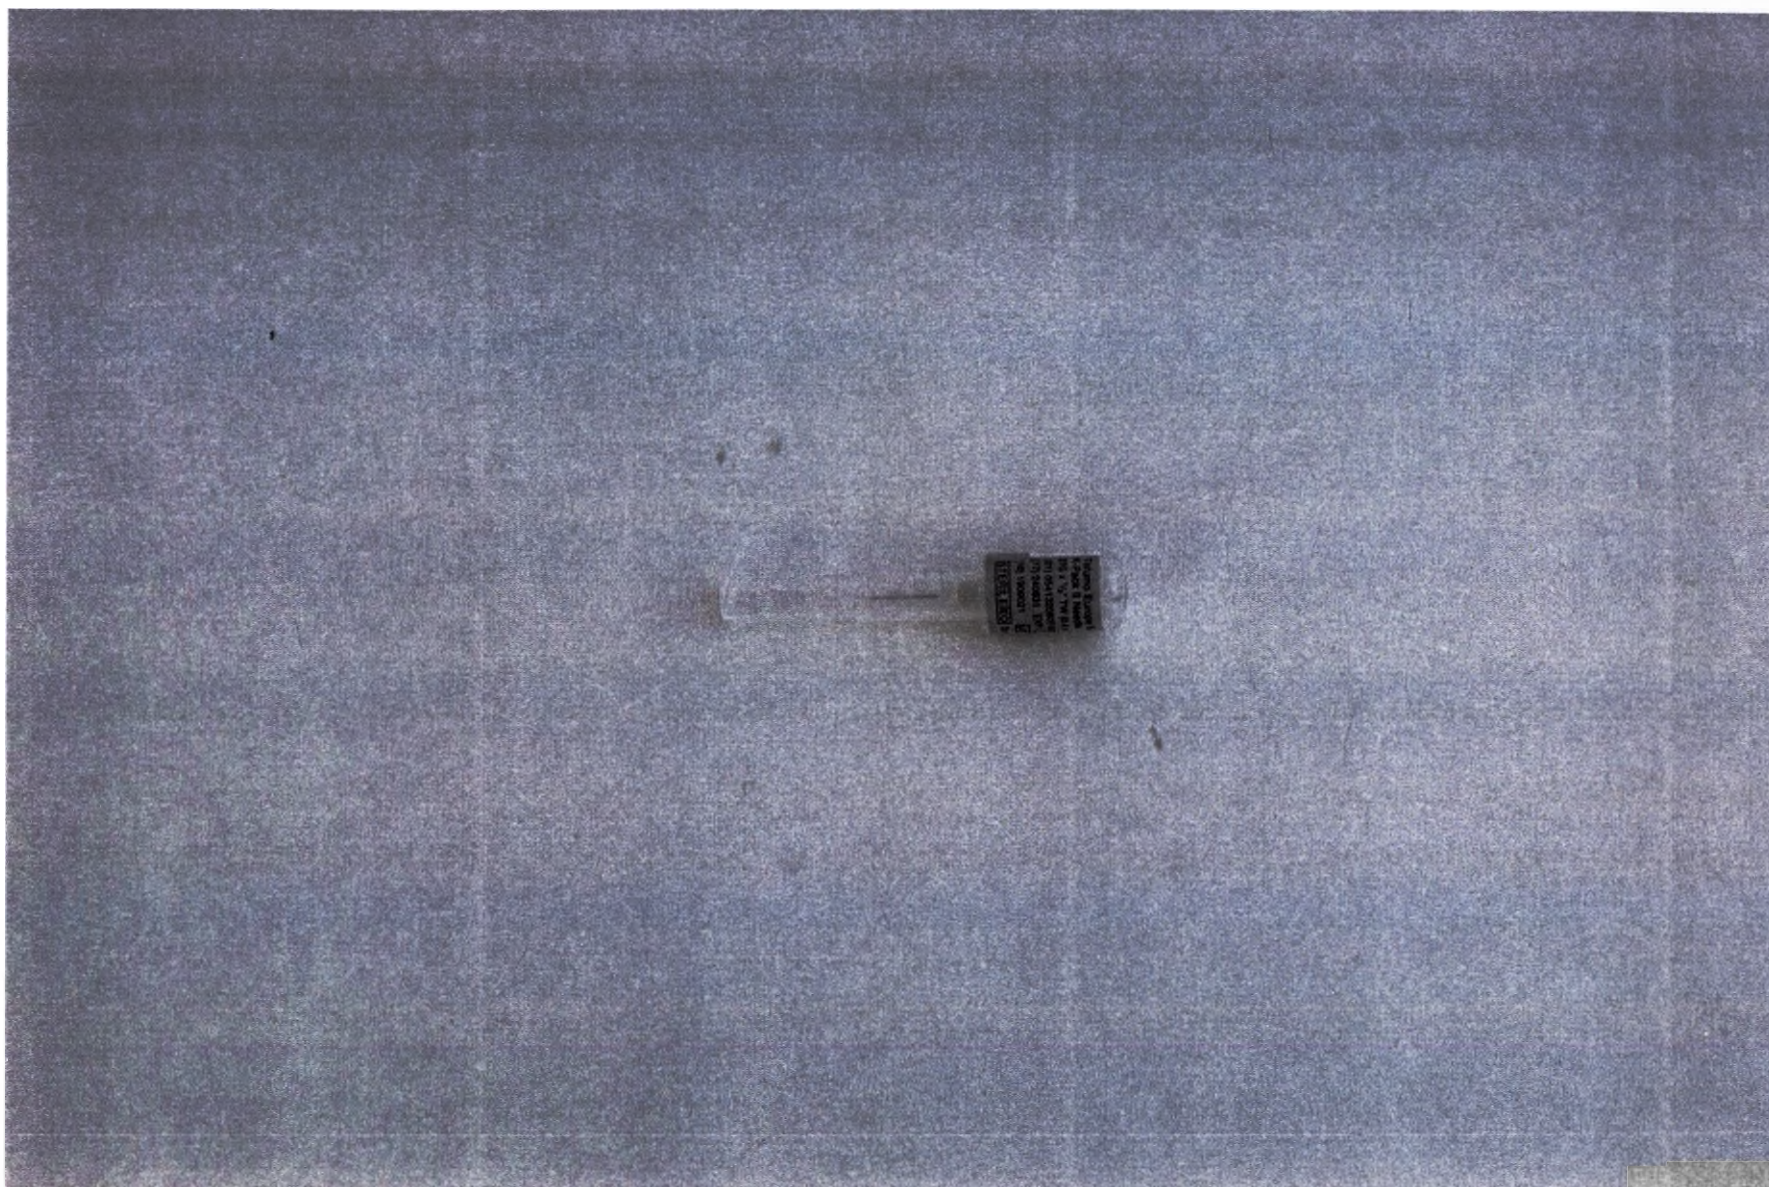


Рис. 38. На фотографии приведен общий вид колпачка с иглой - TERUMO EUROPE N.V., Бельгия

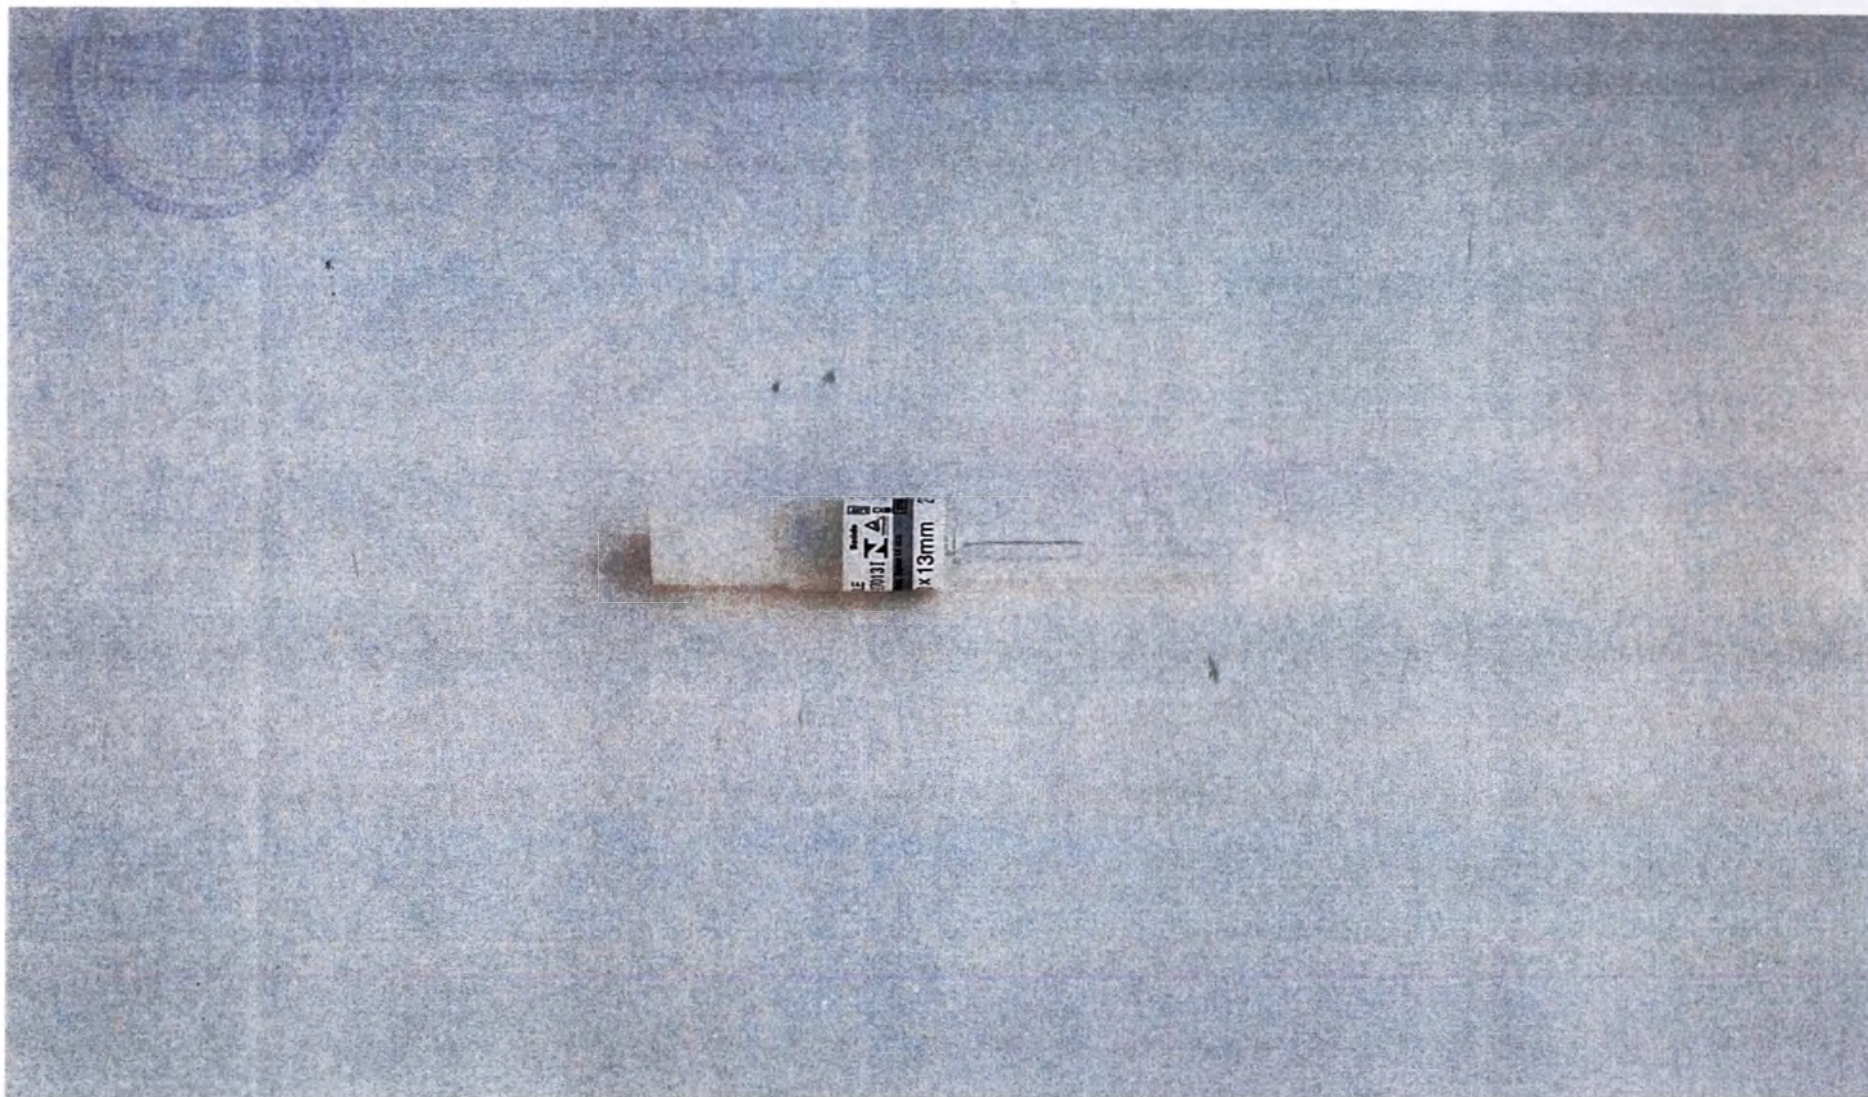


Рис. 39. На фотографии приведен общий вид колпачка с иглой - TSK Laboratory, Япония

Прошито и пронумеровано
скреплено печатью 40
Генеральный директор
ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ»
_____ А.М. Та



_____» июне 2022 г.