

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Вива Виктория»
Субботин А.А.



«01» ноября 2023

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Устройство для измельчения зуба TT Transformer


Устройство для измельчения зуба TT Transformer, в составе:

1. Устройство для измельчения зуба TT Transformer - 1 шт.






Пример маркировки паспортной таблички устройство для измельчения зуба TT Transformer:

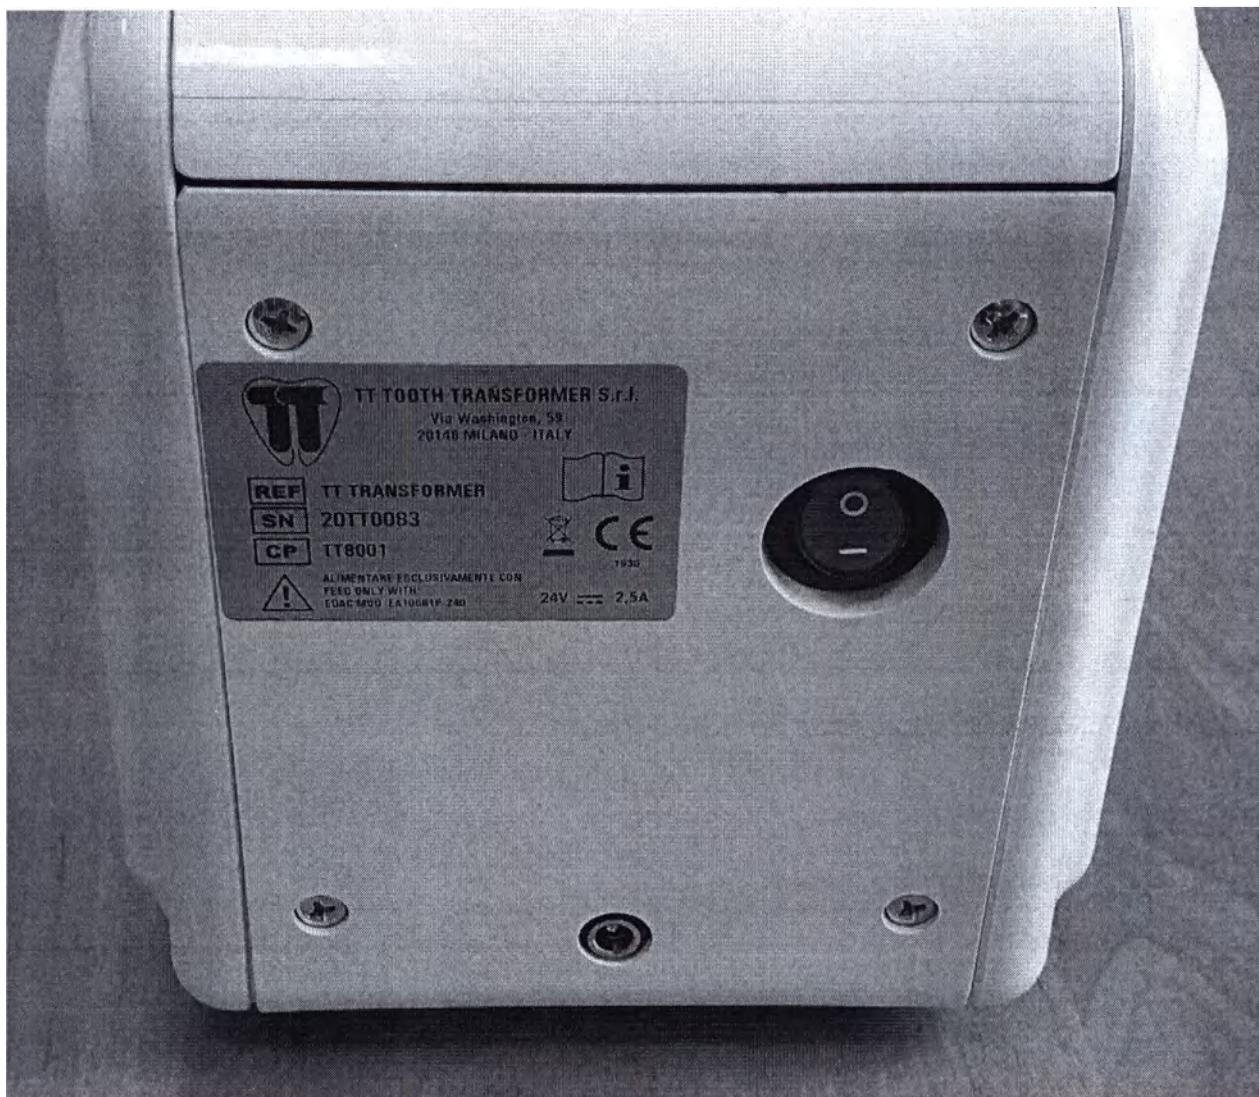

Пример информационной таблички, нанесенной на корпус устройство для измельчения зуба TT Transformer:




2. Измельчитель – 1 шт.

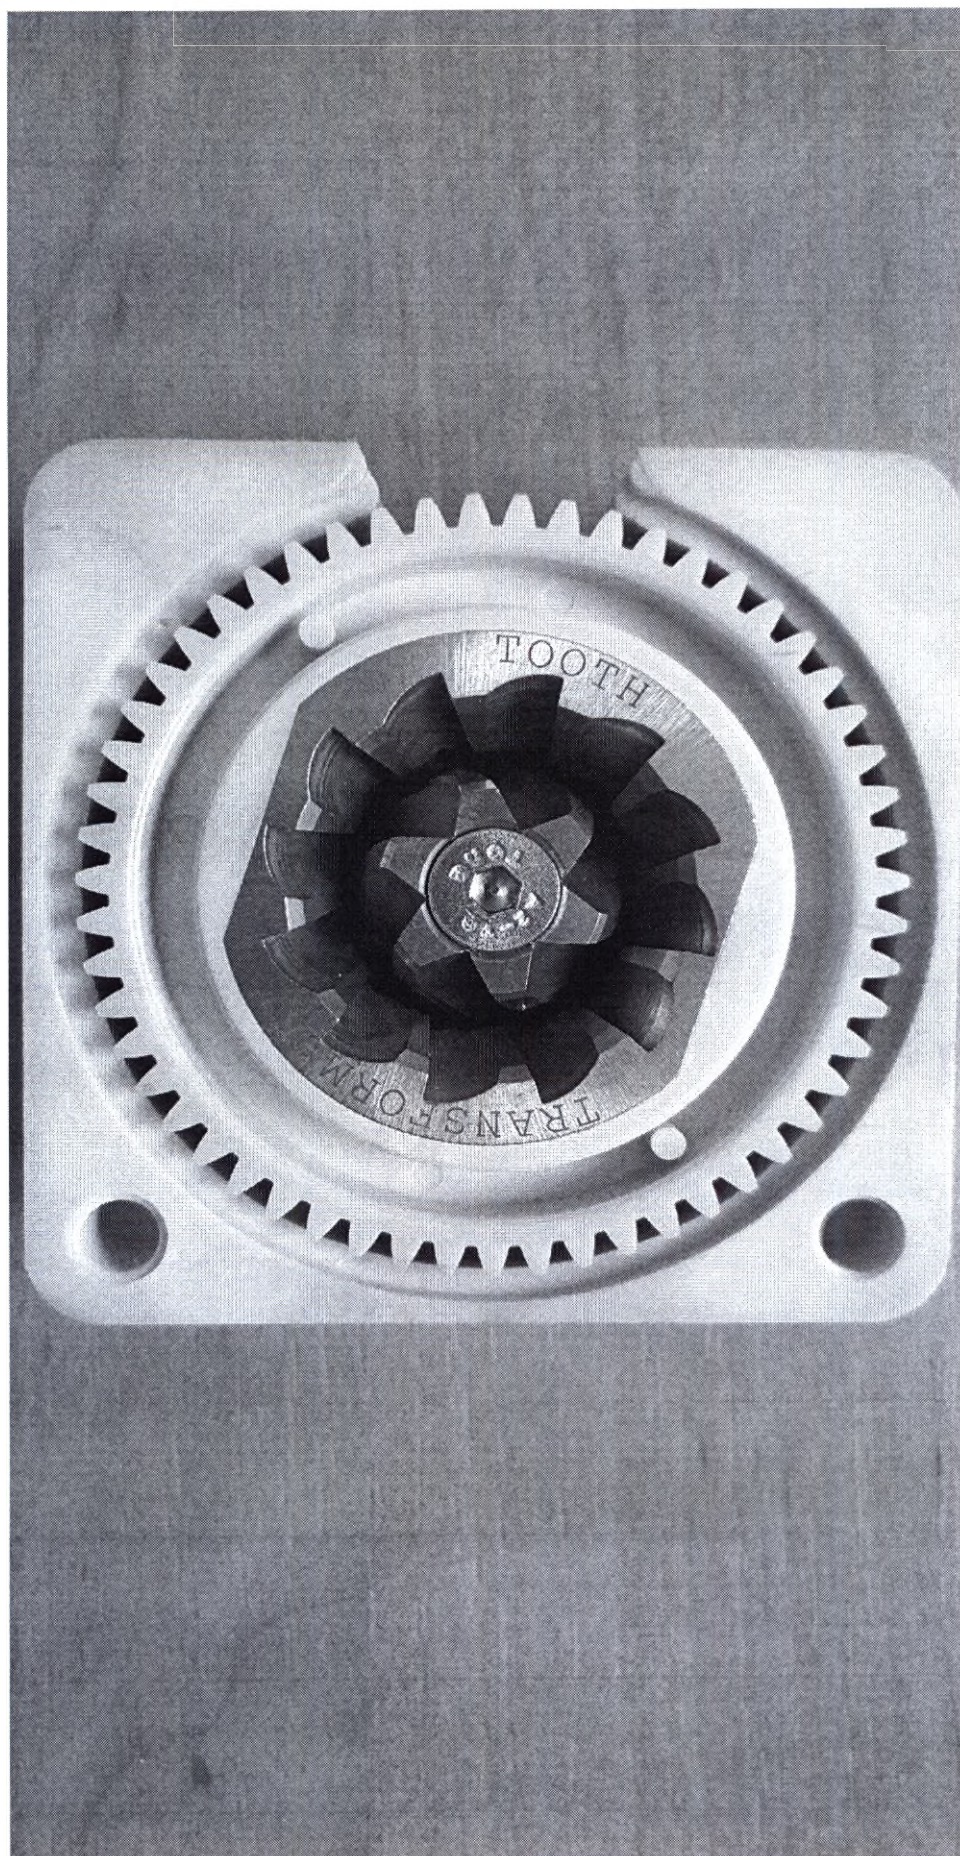

3. Лоток – 1 шт;



4. Внешний блок питания производства EDACPOWER ELEC. (CHINA), модель: EA10681P-240 –1 шт.;

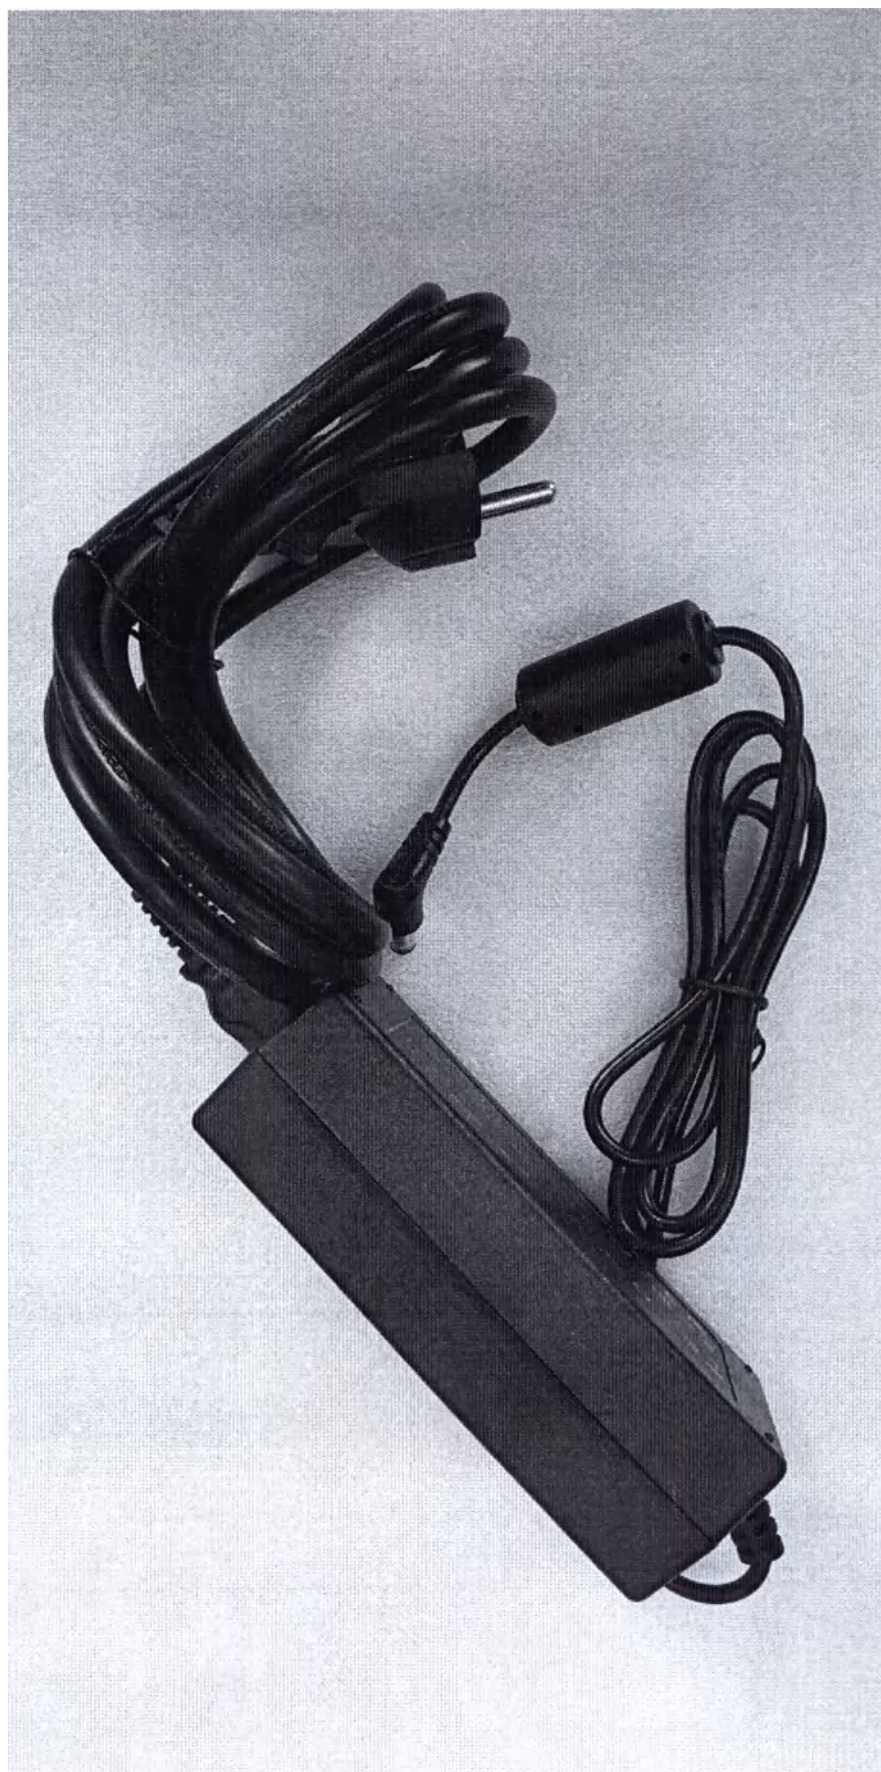

5. Кейс для устройства TT Transformer – 1 шт.;



6. Комплект одноразовых медицинских инструментов для использования с TT Transformer, не более 100 шт./к устройству (при необходимости), в составе:

- Мейкер – 1 шт.;
- Цилиндр – 1 шт.;
- Картридж – 1 шт.



блистер, выполненный из прозрачного ПЭТГ-пластика и медицинской бумаги (1 сторона)

блистер, выполненный из прозрачного ПЭТГ-пластика и медицинской бумаги (2 сторона)




7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.





Транспортная упаковка:

- Устройство для измельчения зуба TT Transformer:



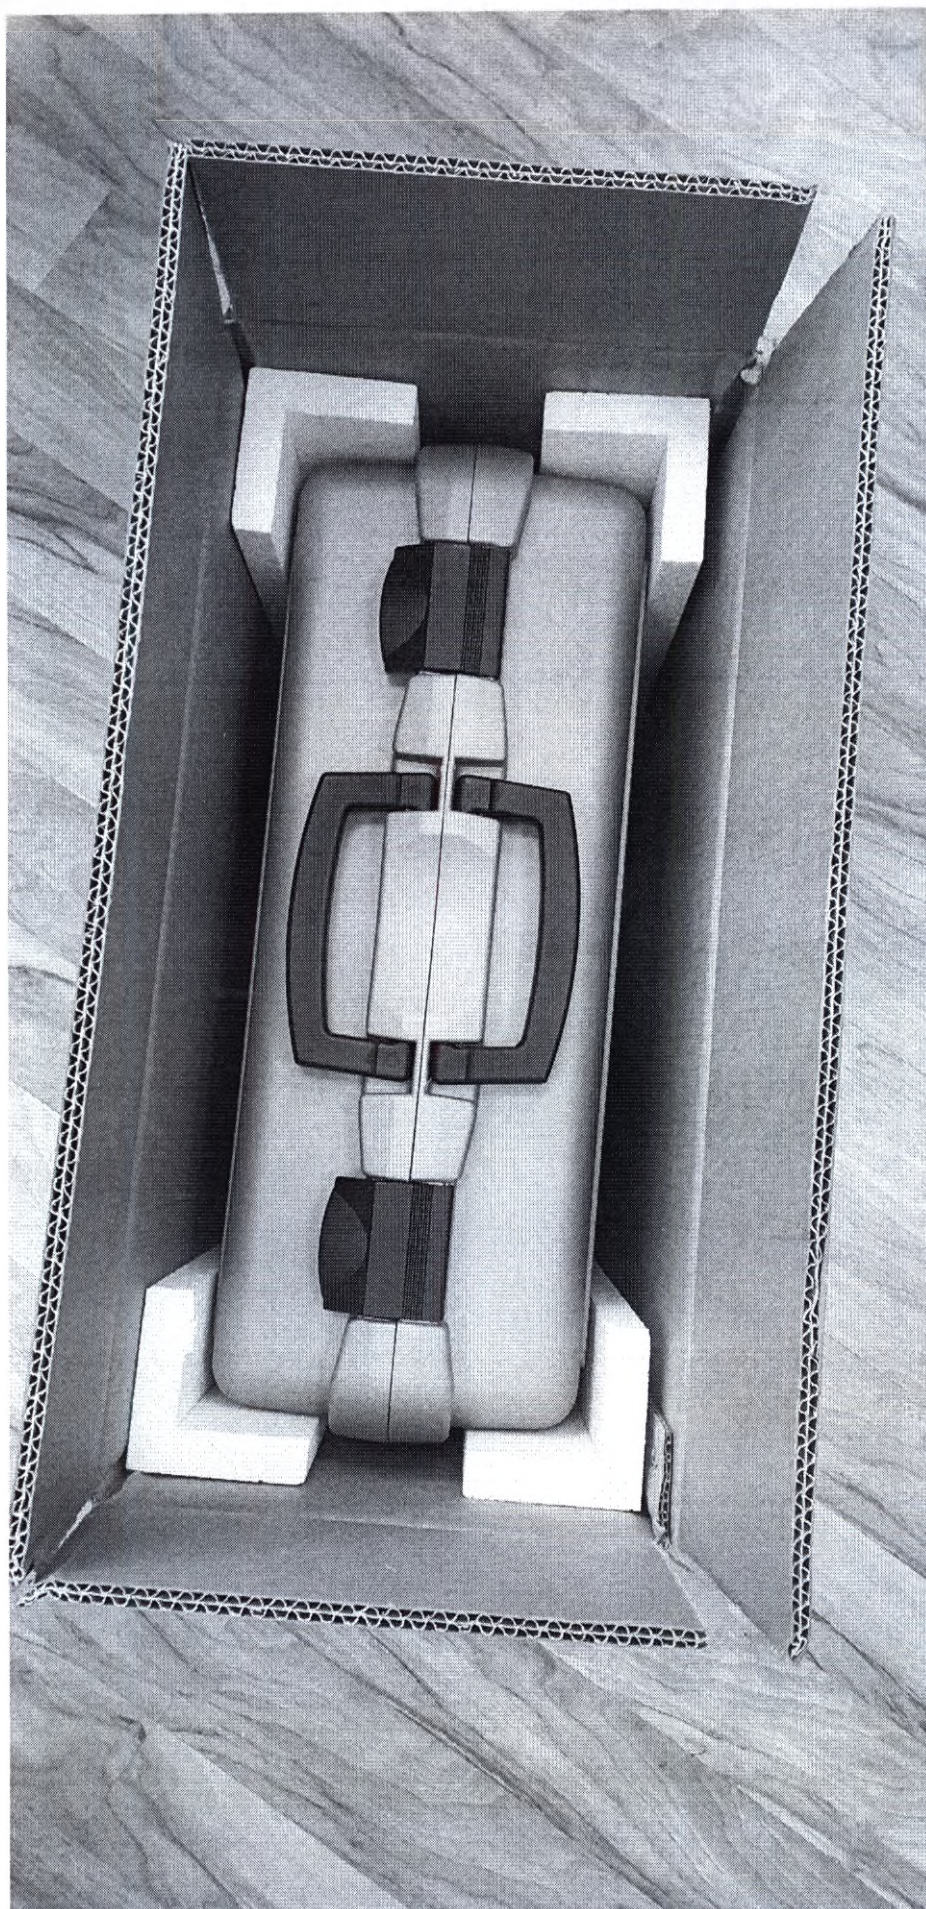

- Комплект одноразовых медицинских инструментов для использования с TT Transformer:

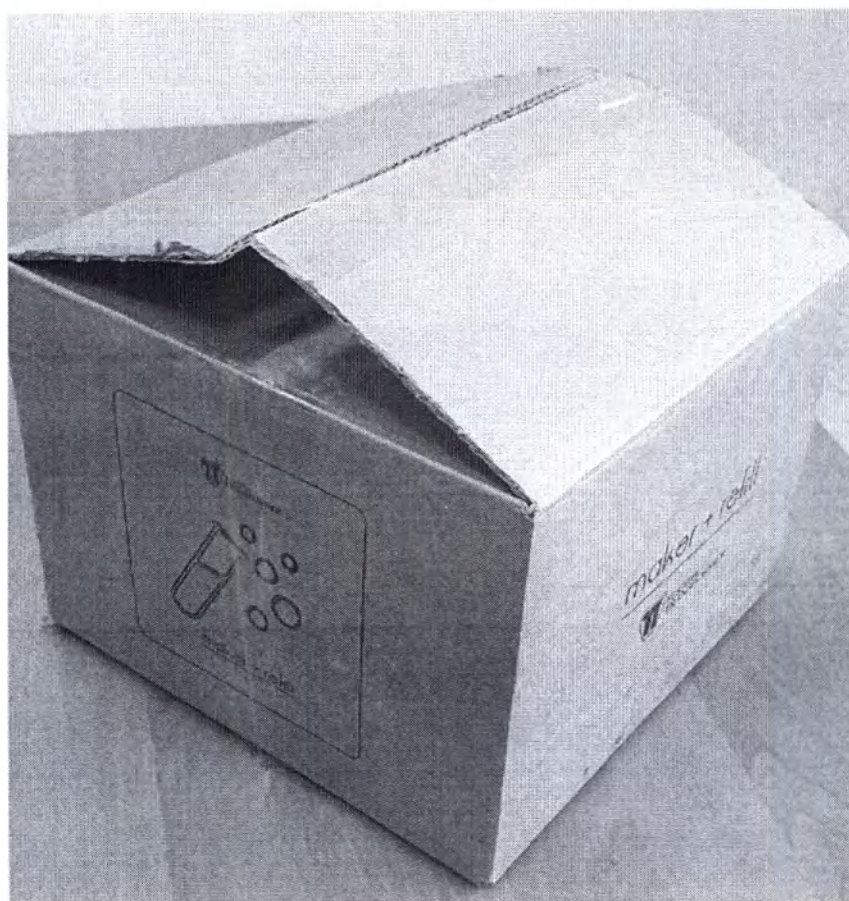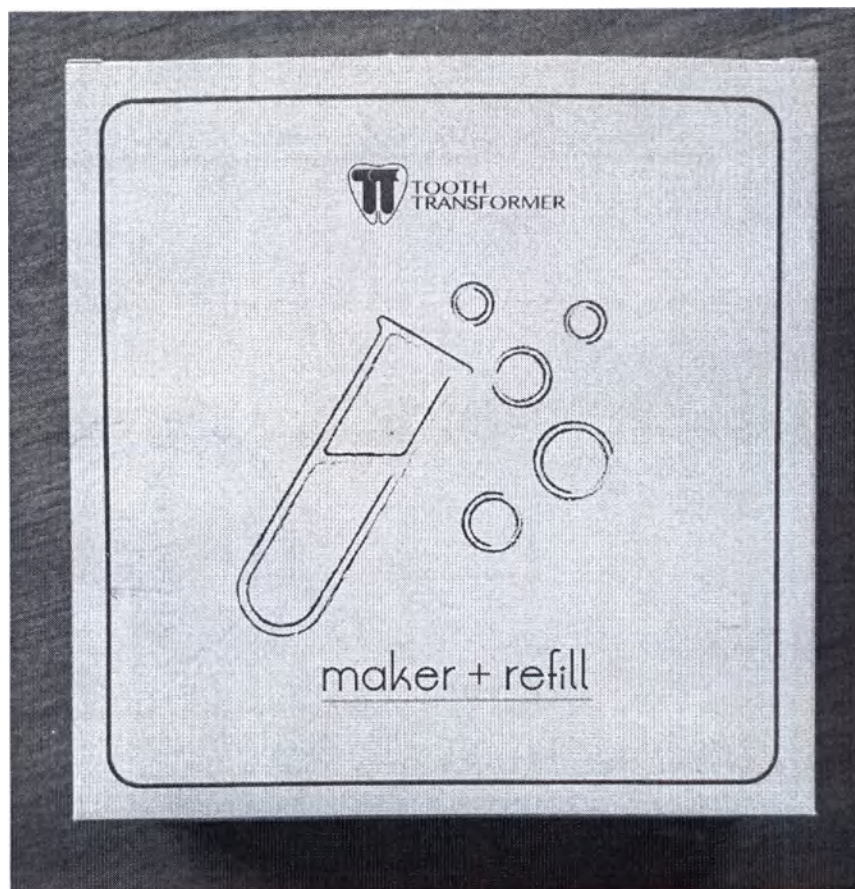

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

15 лист об

Генеральный директор

ООО «Вива Виктория»

А.А. Субботин Субботин А.А.

