

В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения
109074, Москва, Славянская пл., д. 4, стр. 1

Фотографические изображения медицинского изделия

**Машина моюще-дезинфицирующая для гибких эндоскопов
BANDEQ, модель DUO с принадлежностями**

(производство Choyang Medical Industry Ltd., Корея)

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

Каструбина Юлия Сергеевна

Каструбина
(подпись)

"05" *июня* 2023 г.




Машина моюще-дезинфицирующая для гибких эндоскопов BANDEQ модель DUO



Маркировка (макет на русском языке)

REF	BANDEQ DUO		
Требования к электропитанию	220-230V~, 50/60Hz, 1.2 KW		
		SN	
	Choyang Medical Industry Ltd. 5Fl., Joongil Eines Platz III, 519, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 462-807, Korea Тел : +82-31-747-9900 Факс : +82-31-747-9901 http://www.choyangmed.com		
Машина моюще-дезинфицирующая для гибких эндоскопов BANDEQ, модель DUO с принадлежностями РУ № РЗН _____			
	Сделано в Корее		


Решетка

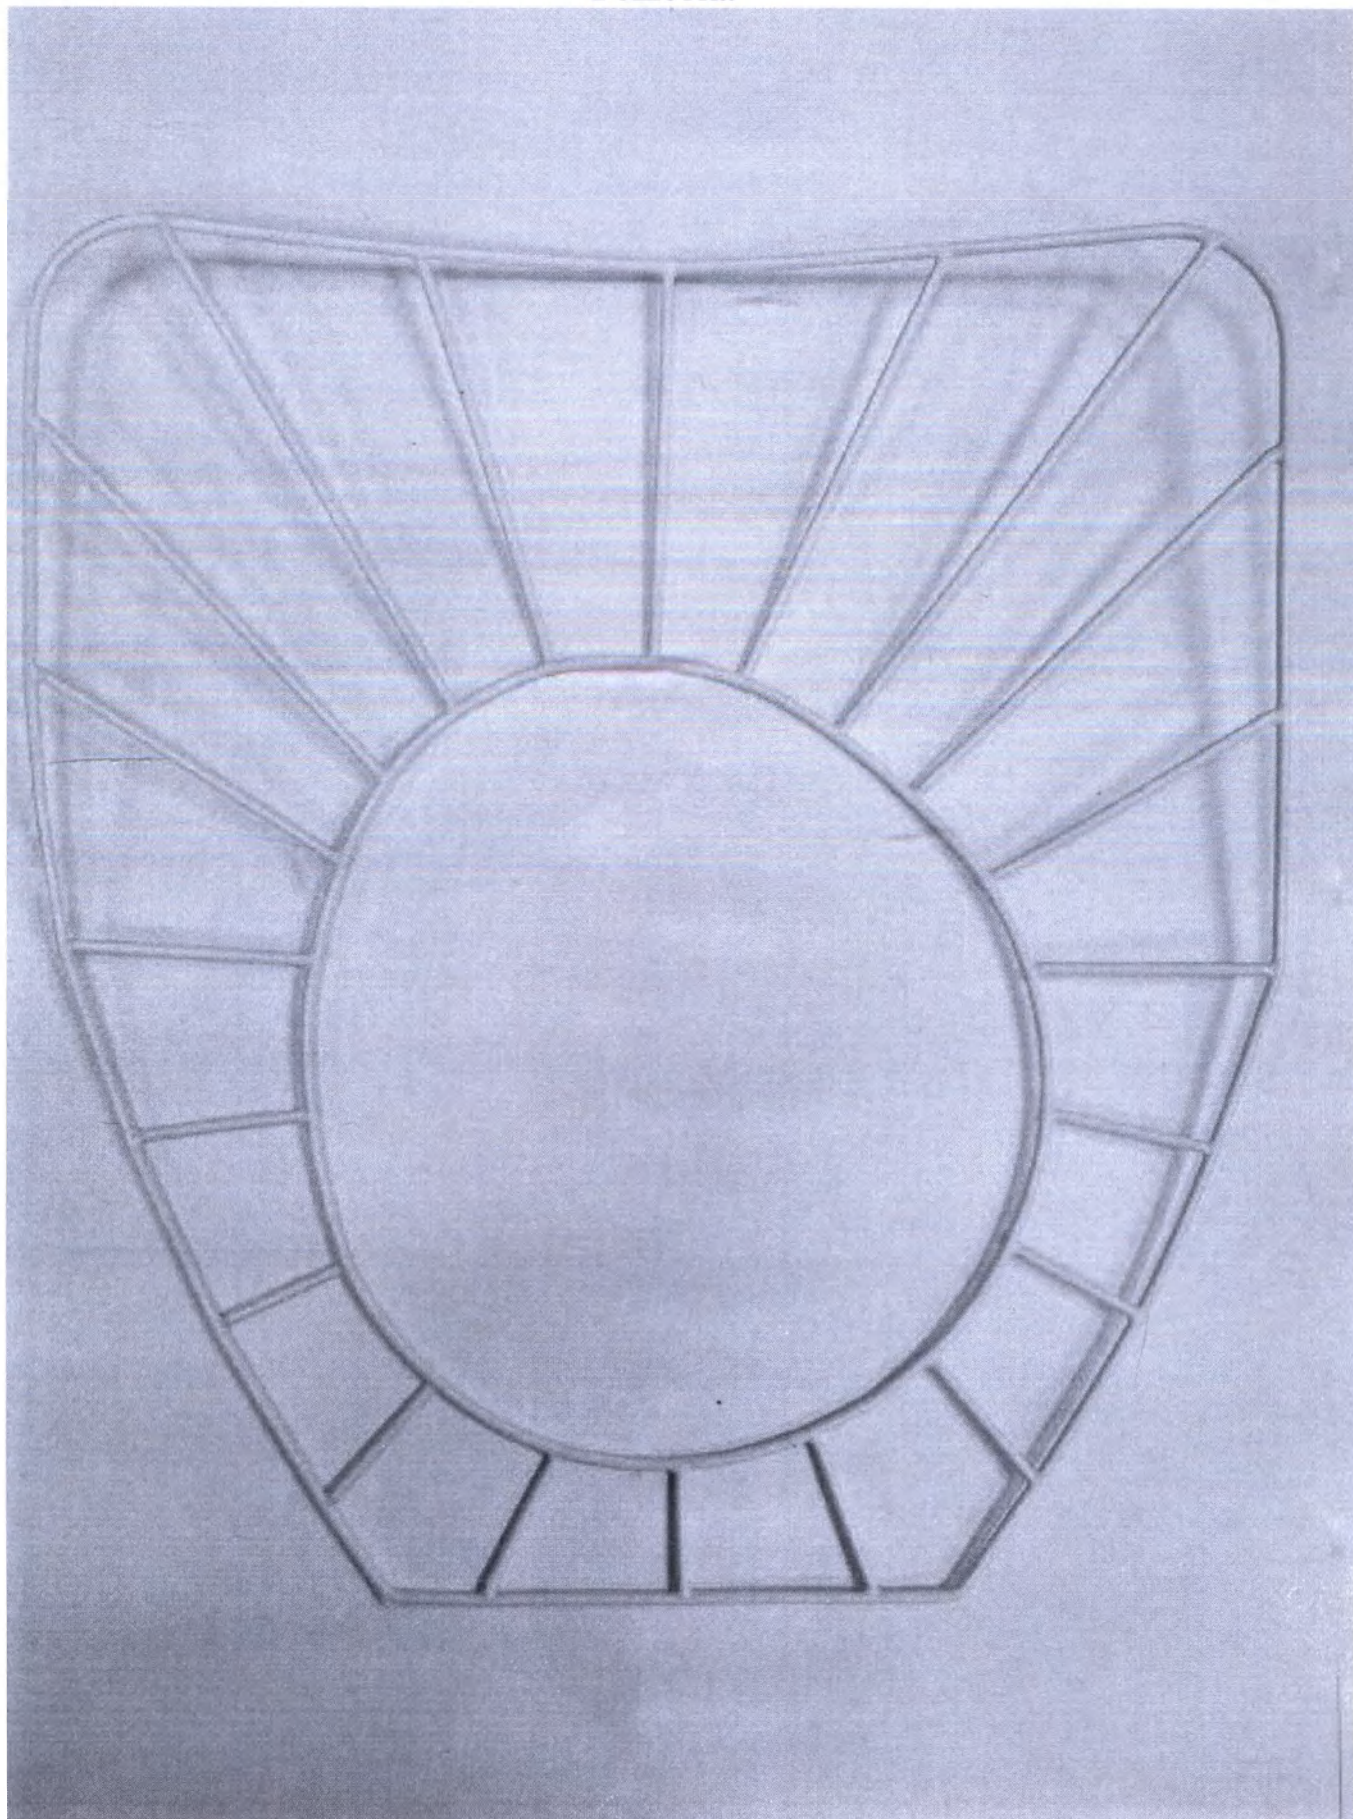


Корзинка для аксессуаров




Трубка подключения канала

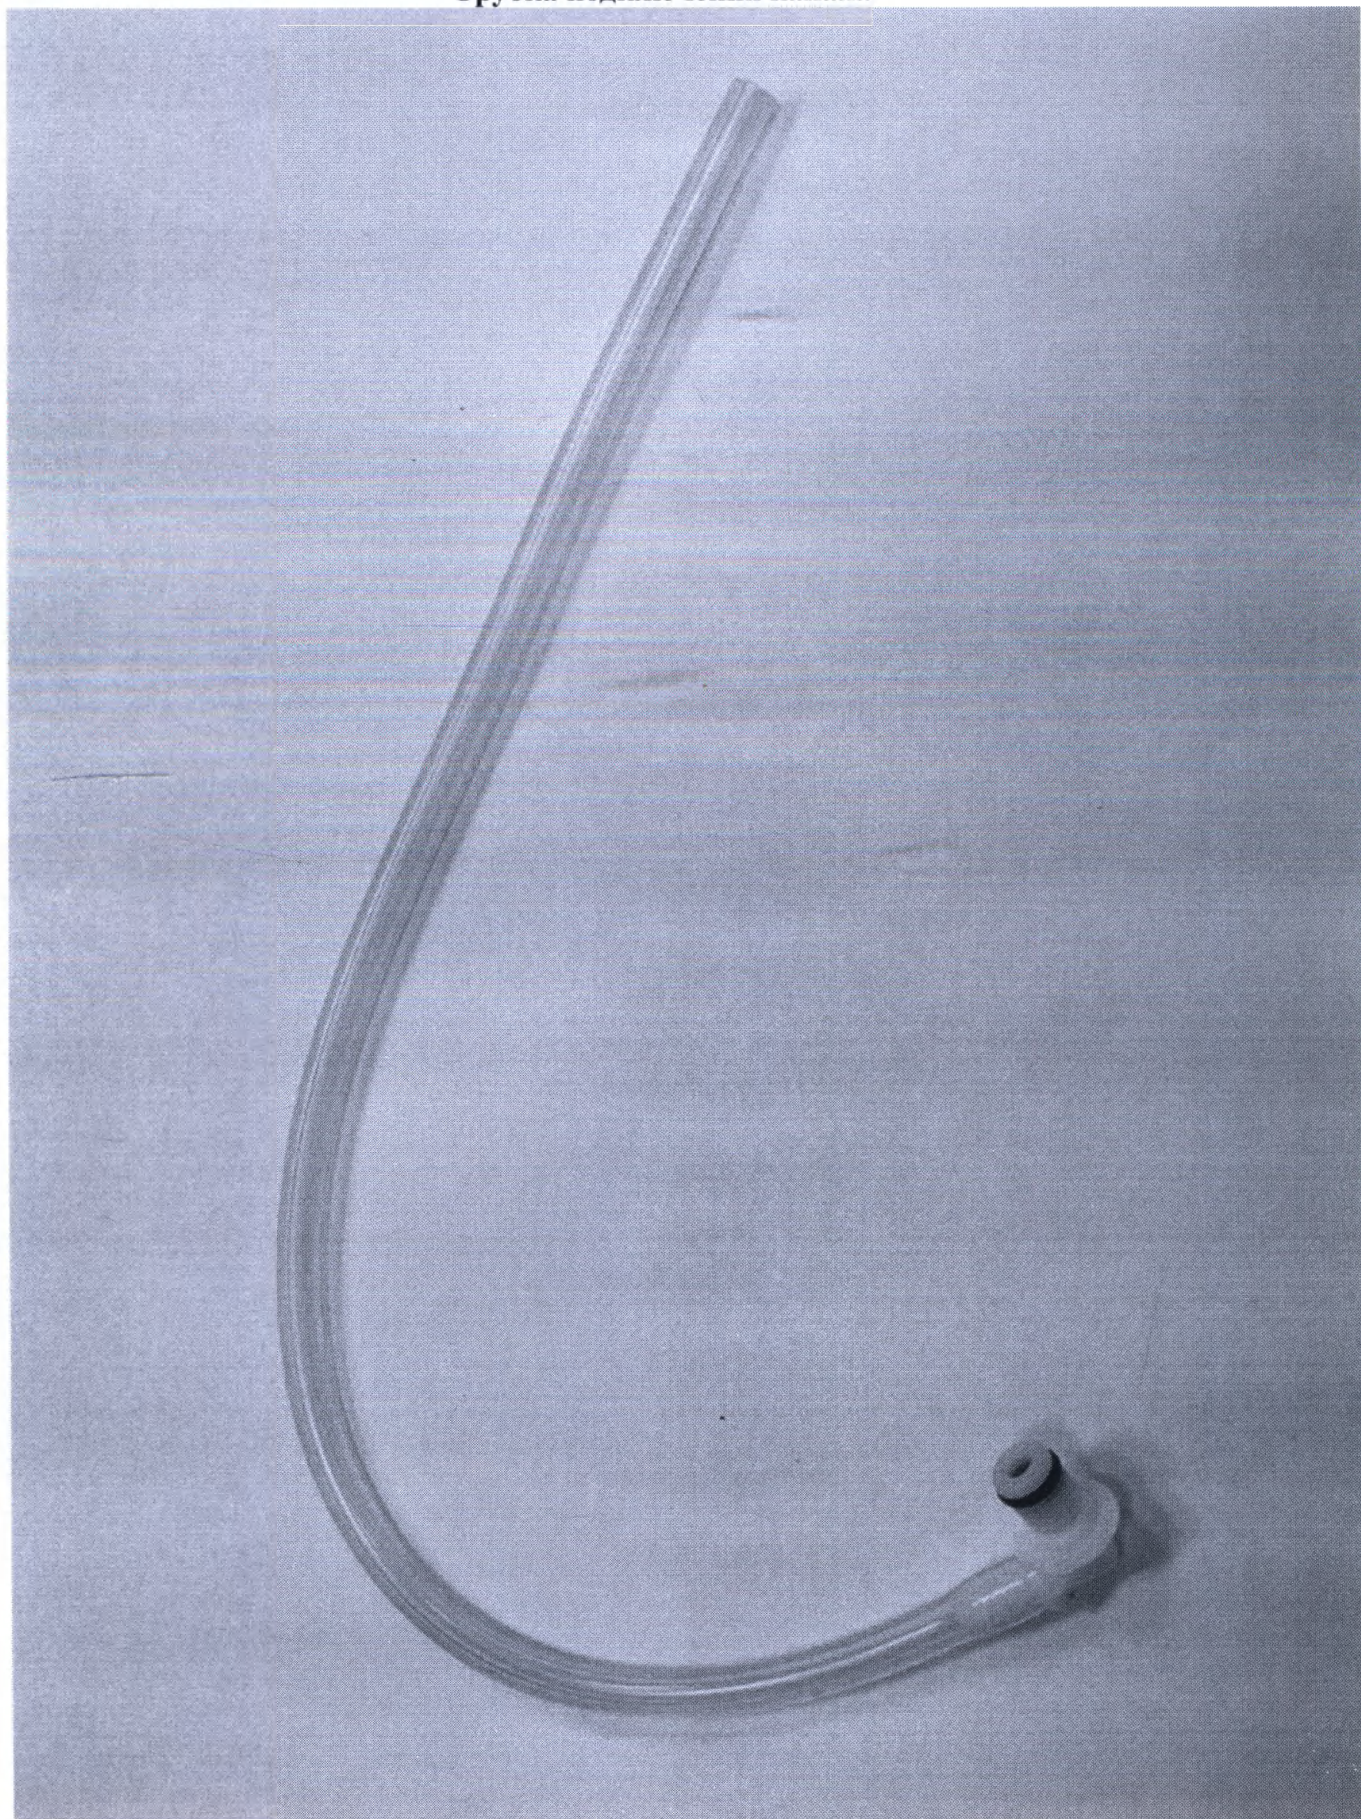


Сливная трубка

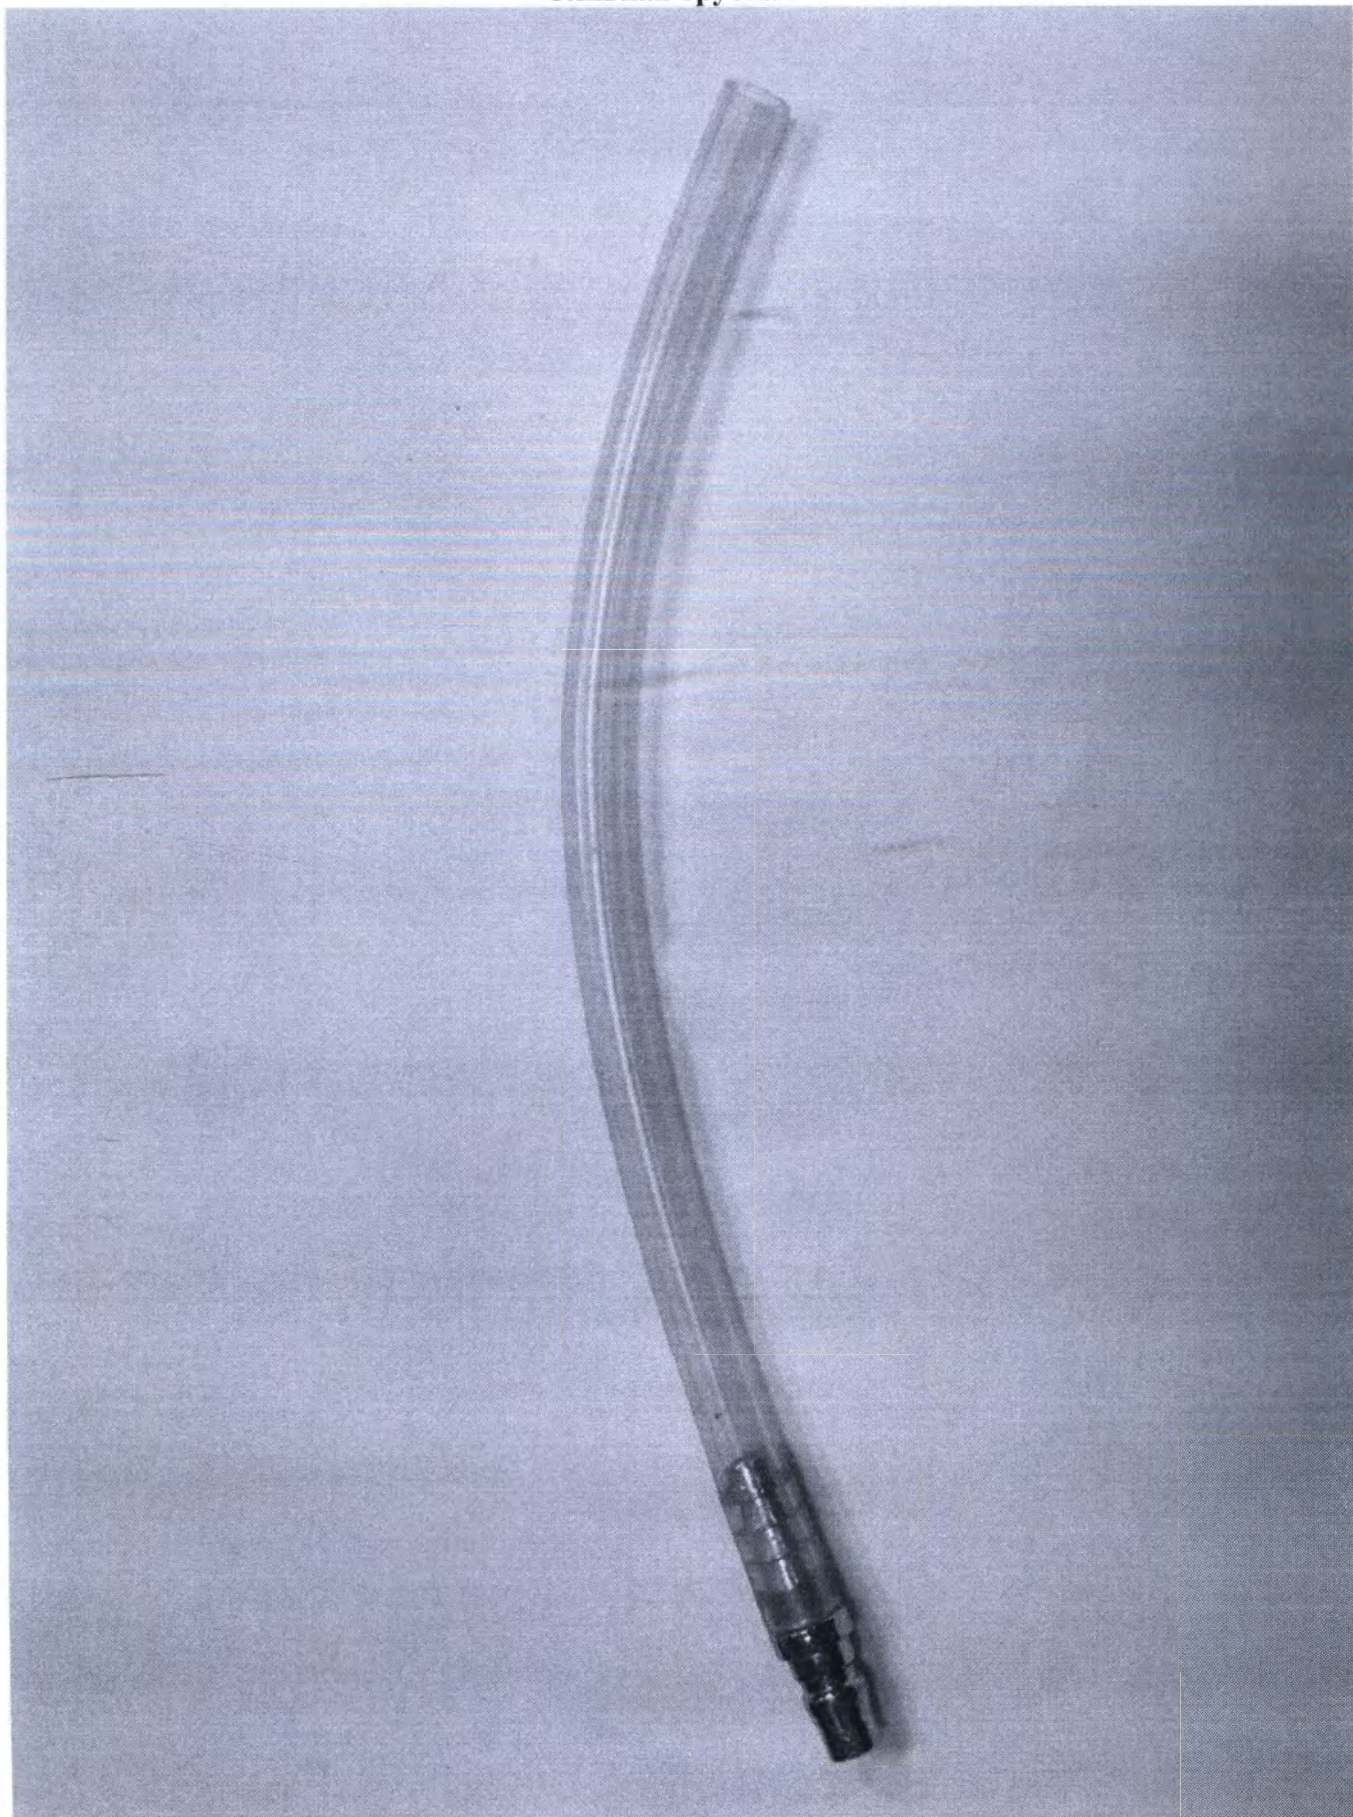


Аспирационная трубка

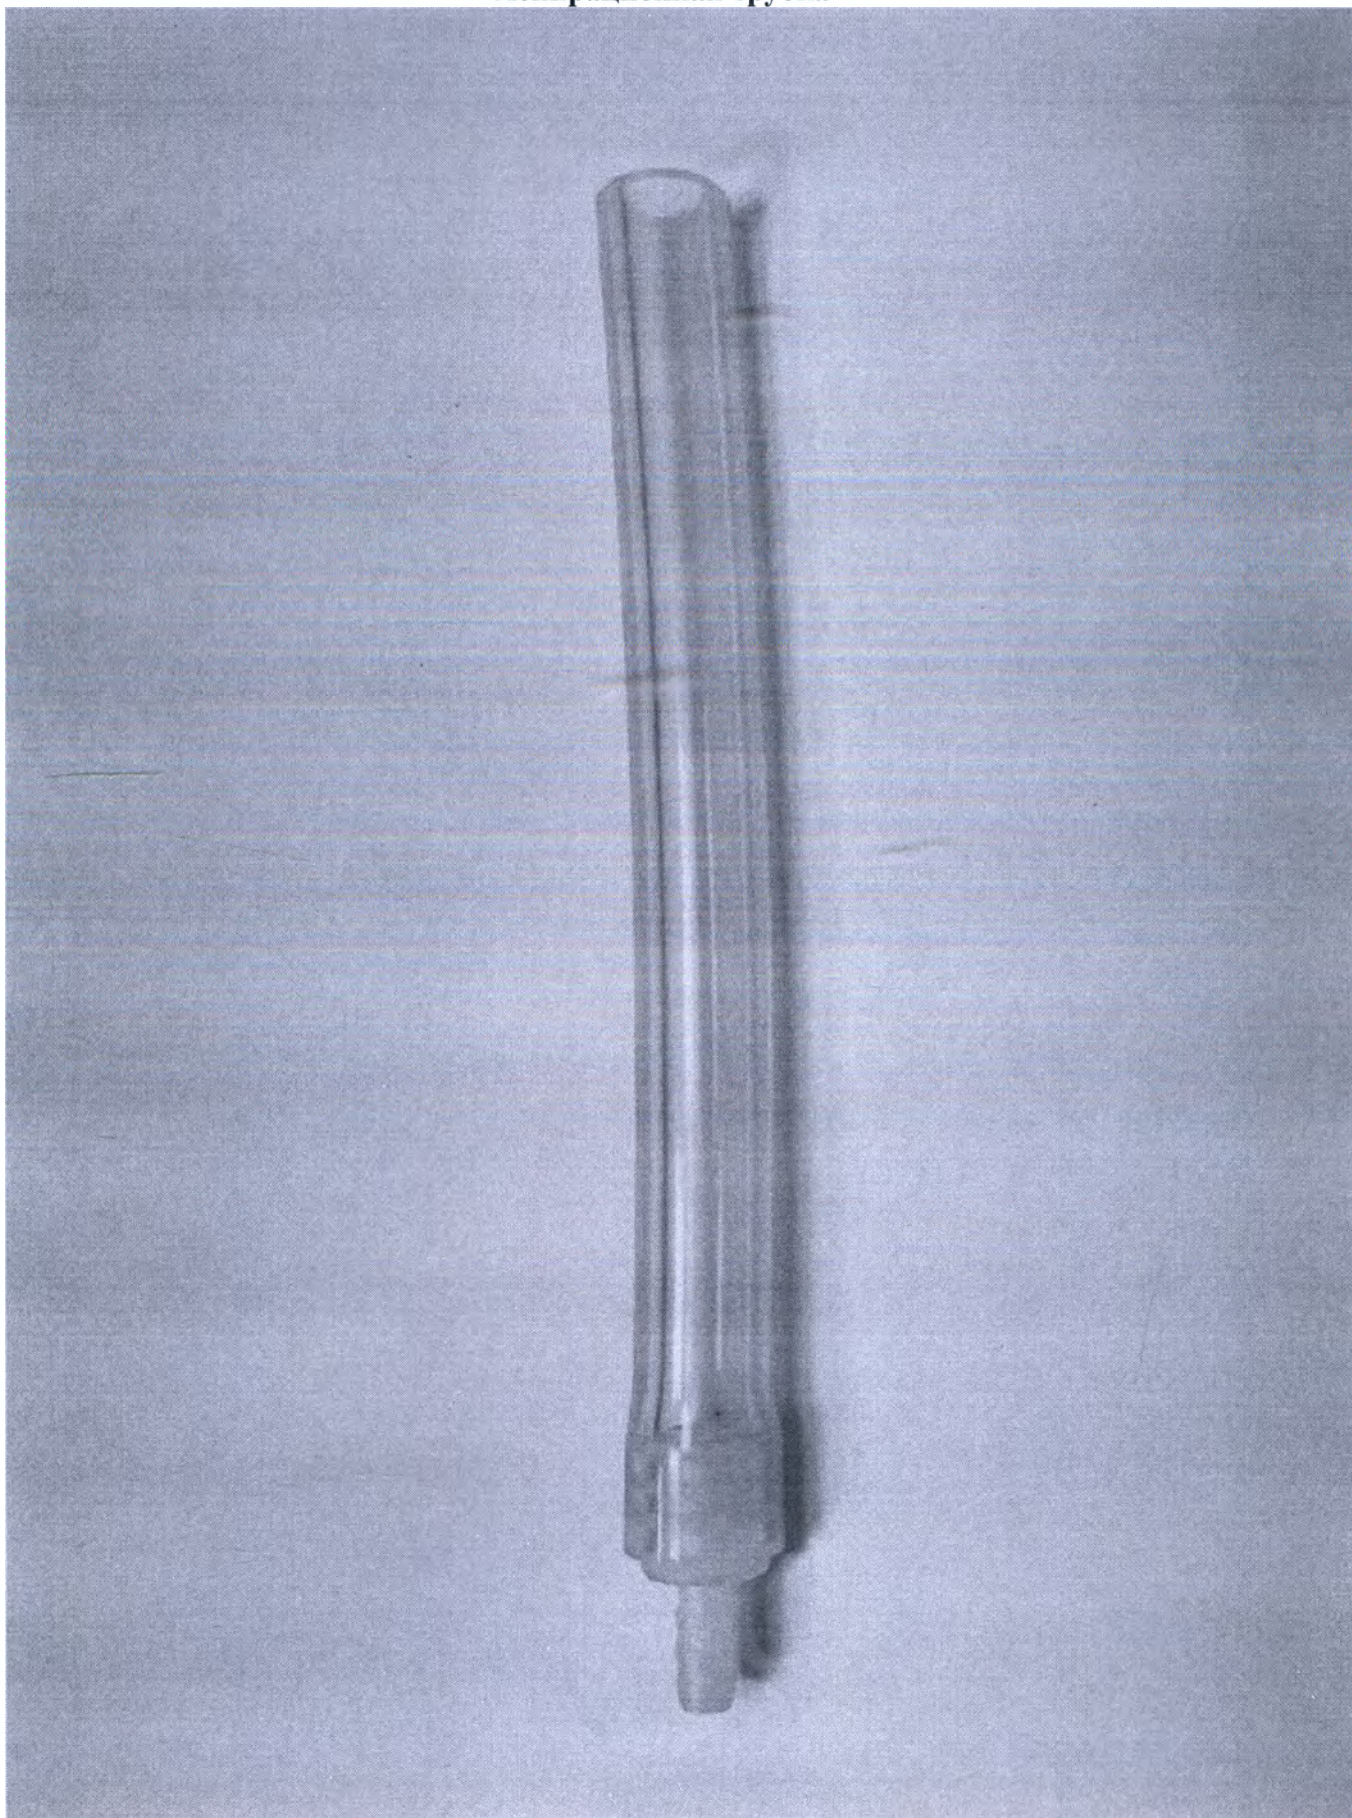


Трубка для проверки на герметичность

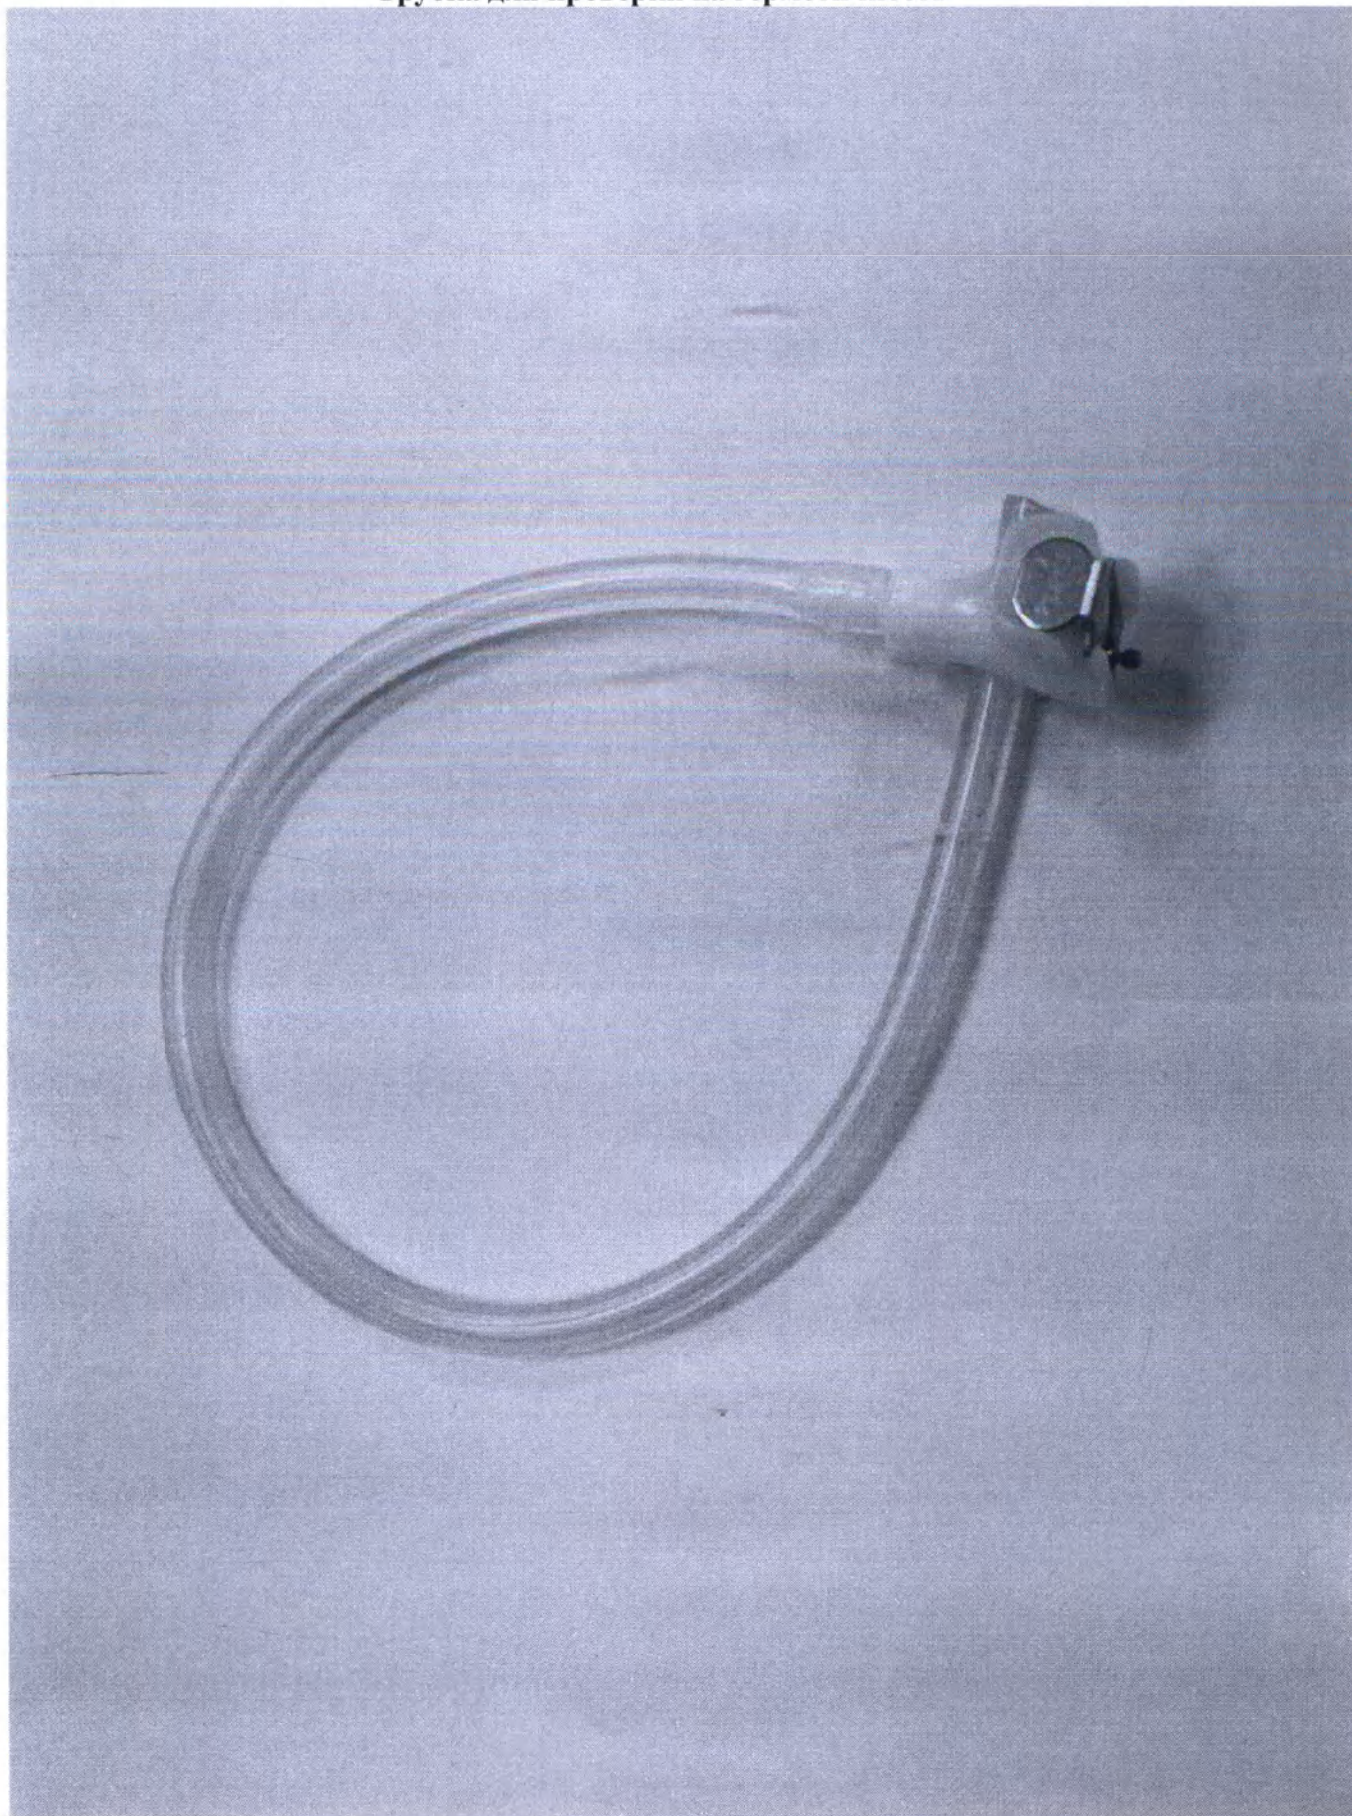


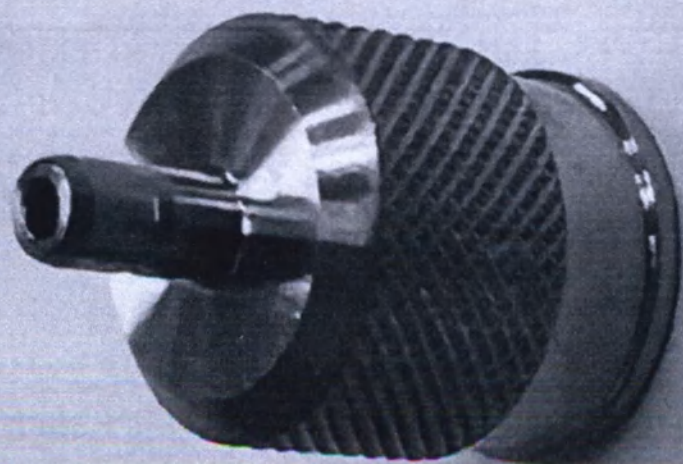


Olympus

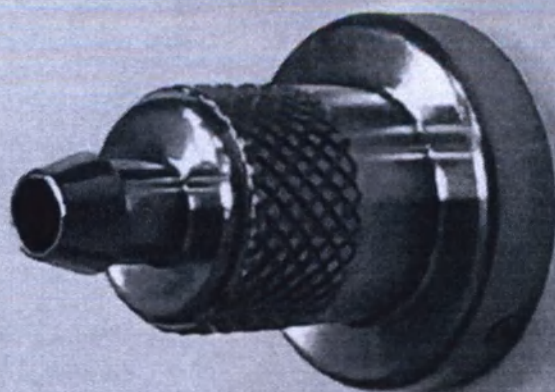


Fujinon

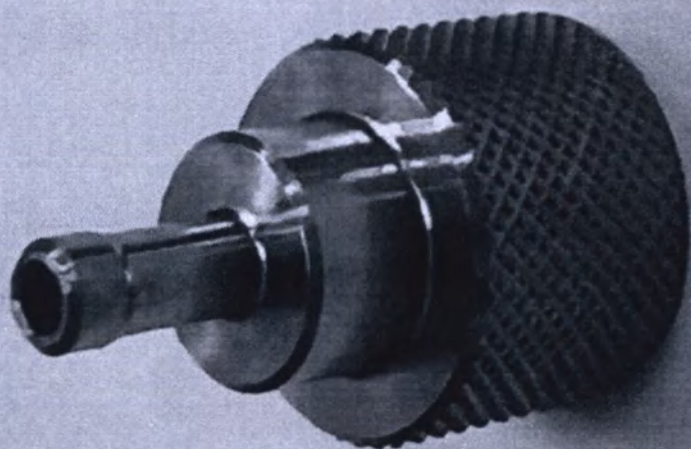

Pentax

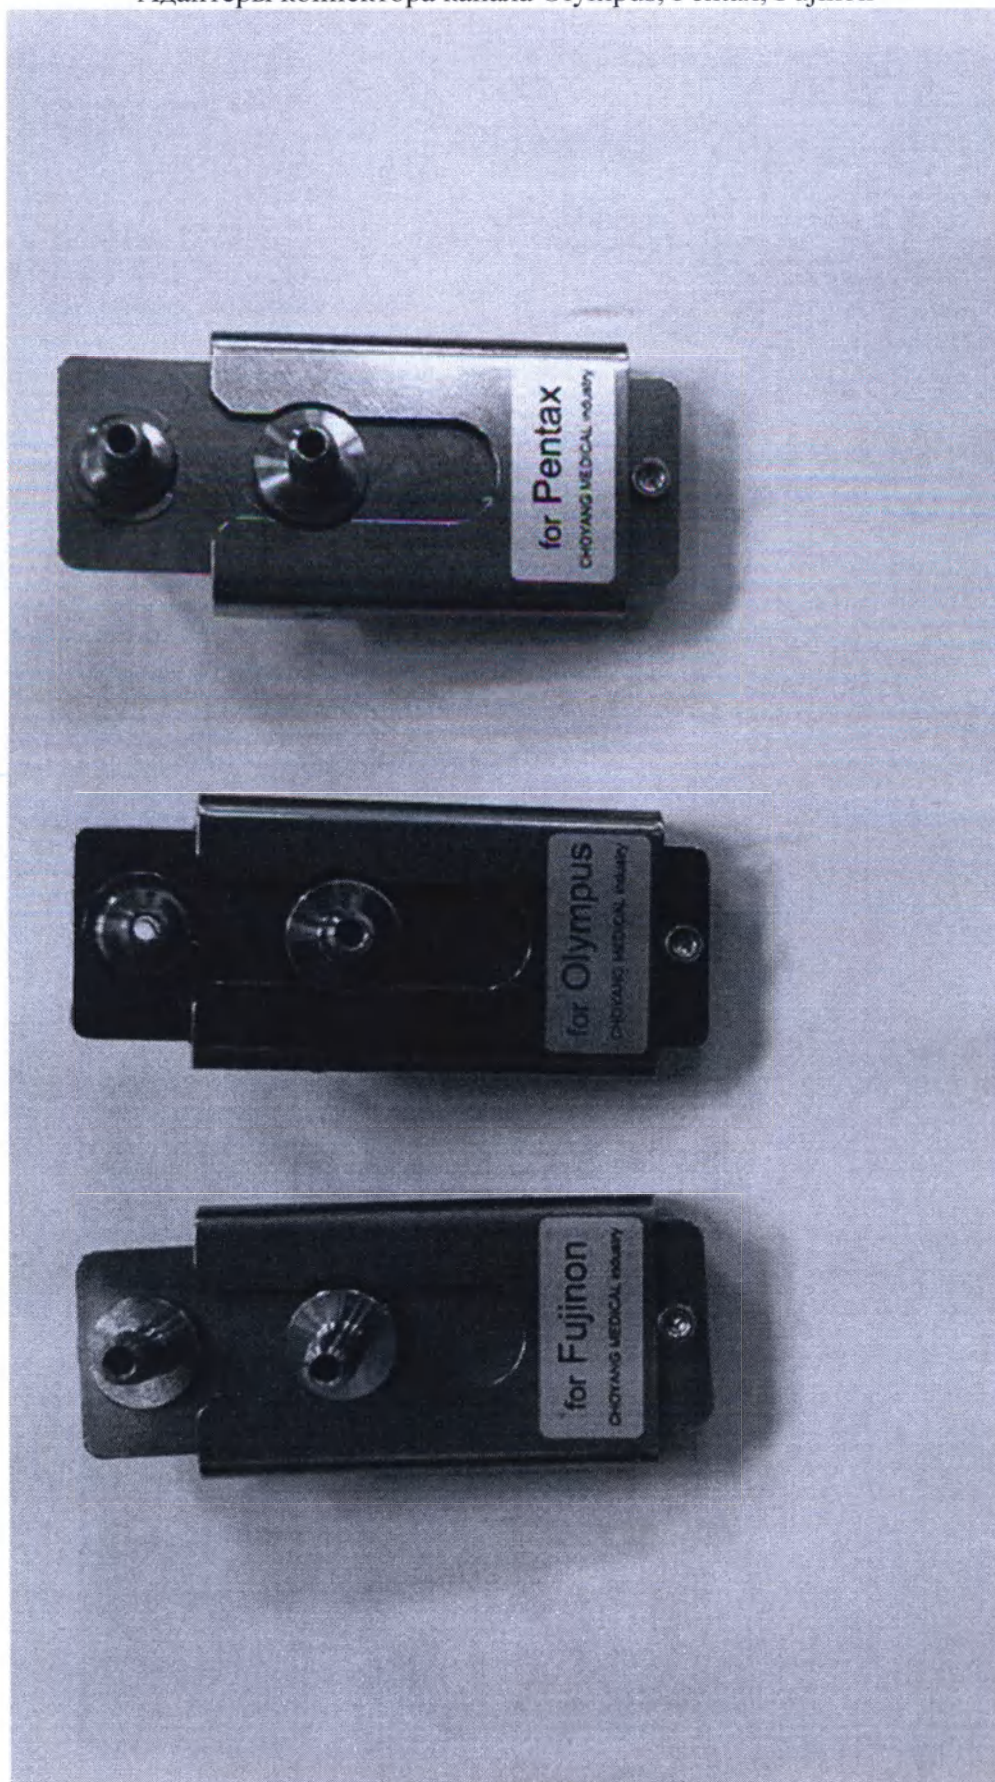

Адаптер подачи и слива воды

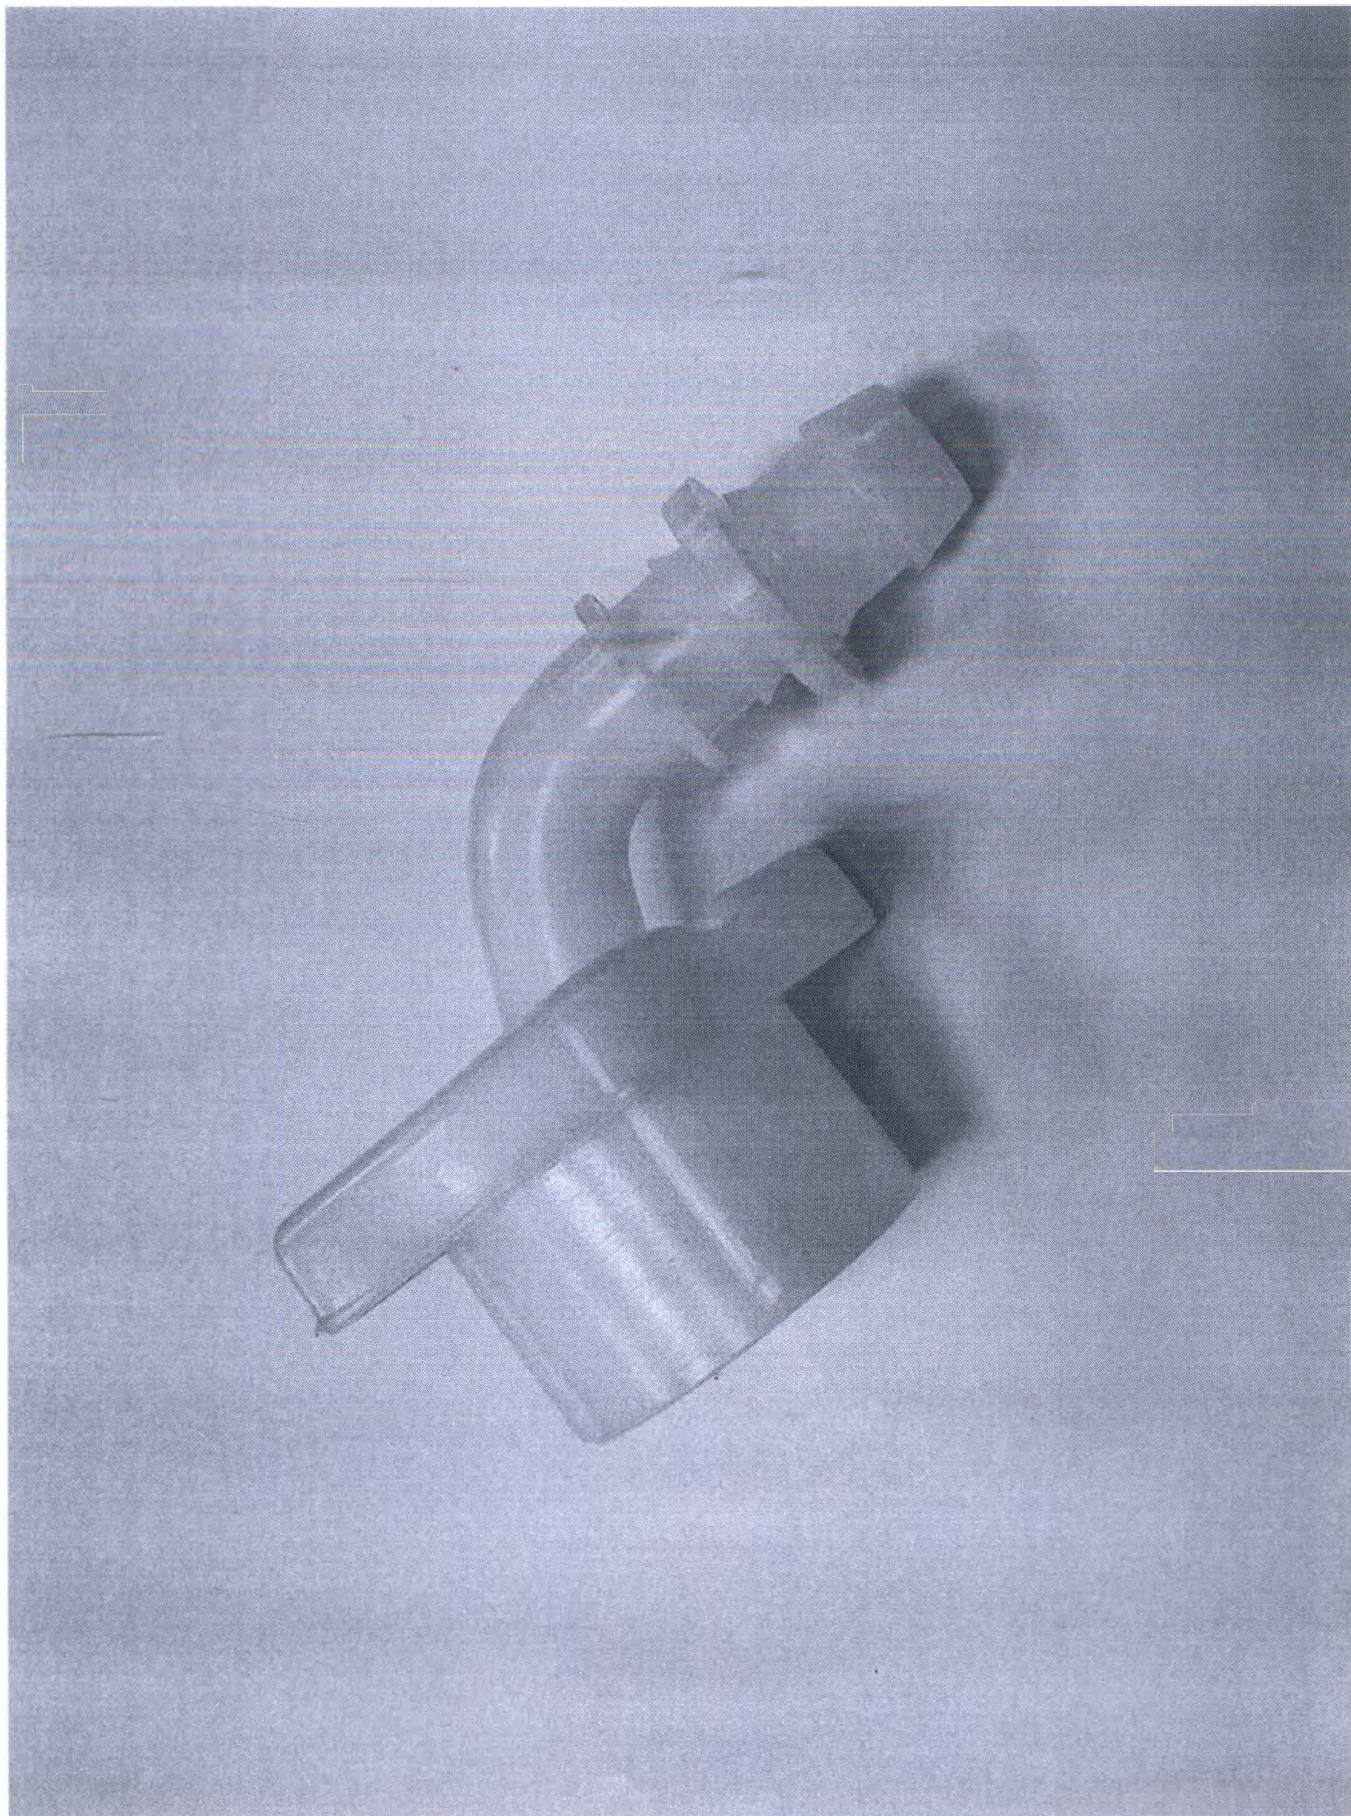

BANDEQ DUO

CE 0120

Машина моеюще-дезинфицирующая для гибких эндоскопов BANDEQ модель DUO

Руководство по эксплуатации



CMI CHOYANG
MEDICAL INDUSTRY



5Fl., Joongil Eines Platz III, 519, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 462-807, Korea

Tel: +82 31 747 9900. Fax: +82 31 747 9901 <http://www.choyangmed.com>

Итого прошнуровано и
пронумеровано 13
(тринадцать) лист об

Генеральный директор
И.С. Каструбина

