


Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия

Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного
звукопроведения цифровой программируемый «Аурика» «Вита» по ТУ
26.60.14-020-81271212-2017, варианты исполнения, с принадлежностями


производства ООО «Аурика»



Аппарат слуховой электронный реабилитационный воздушного звукопроведения цифровой программируемый
«Аурика» «Вита» по ТУ 26.60.14-020-81271212-2017 (на примере варианта исполнения «Вита T12S»)

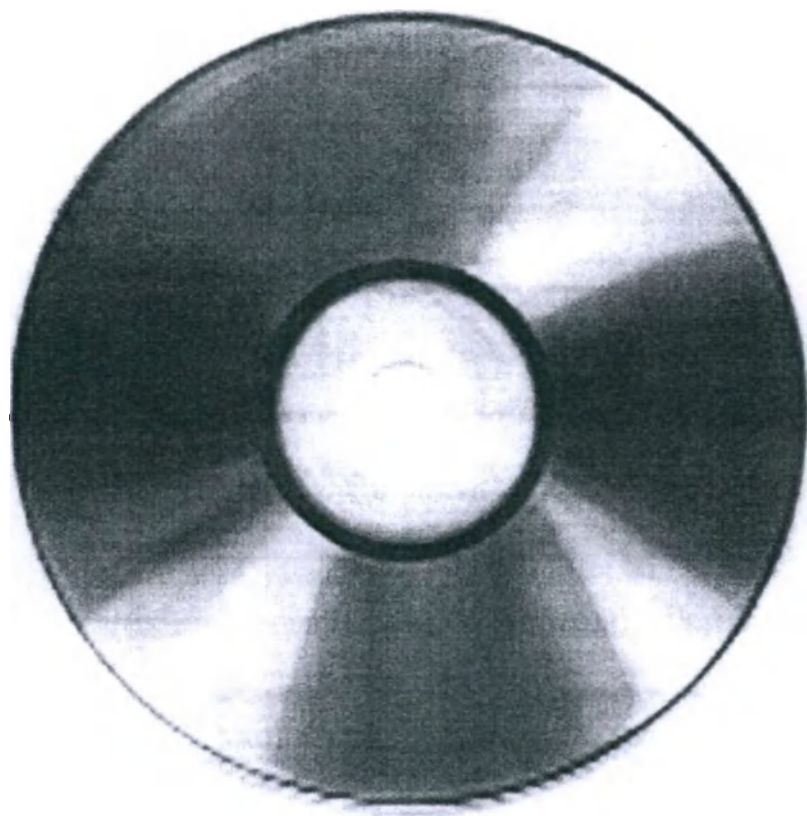

Программное обеспечение для программирования Аурика

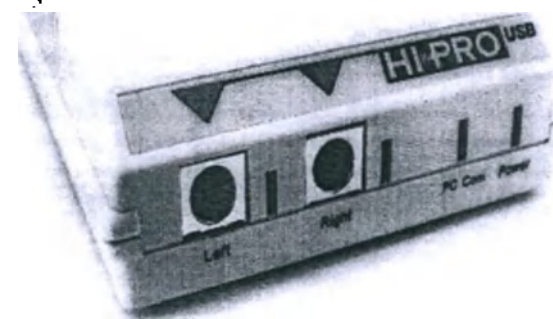

Программатор HI PRO USB



Адаптер для программирования



Каблучок для программирования



Элемент питания: батареи типоразмера: 312, 13, 675 (слева направо), упаковка из 6 шт.



Элемент питания: Аккумуляторная батарея типоразмера: 675, 13, 312 (слева направо), упаковка из 6 шт.

Детский рожок

Звукопроводящая трубка OpenFit




Ушной вкладыш



Переходник под 13 элемент



Шнур программирования (Правый)

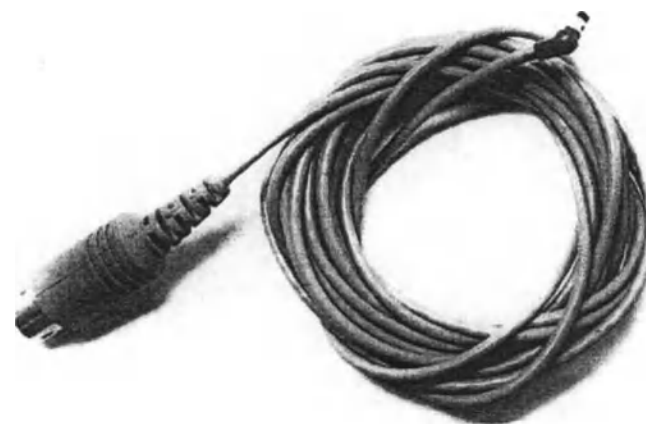

Шнур программирования (Левый)




Аудио-шнур




FM-адаптер



FM-передатчик

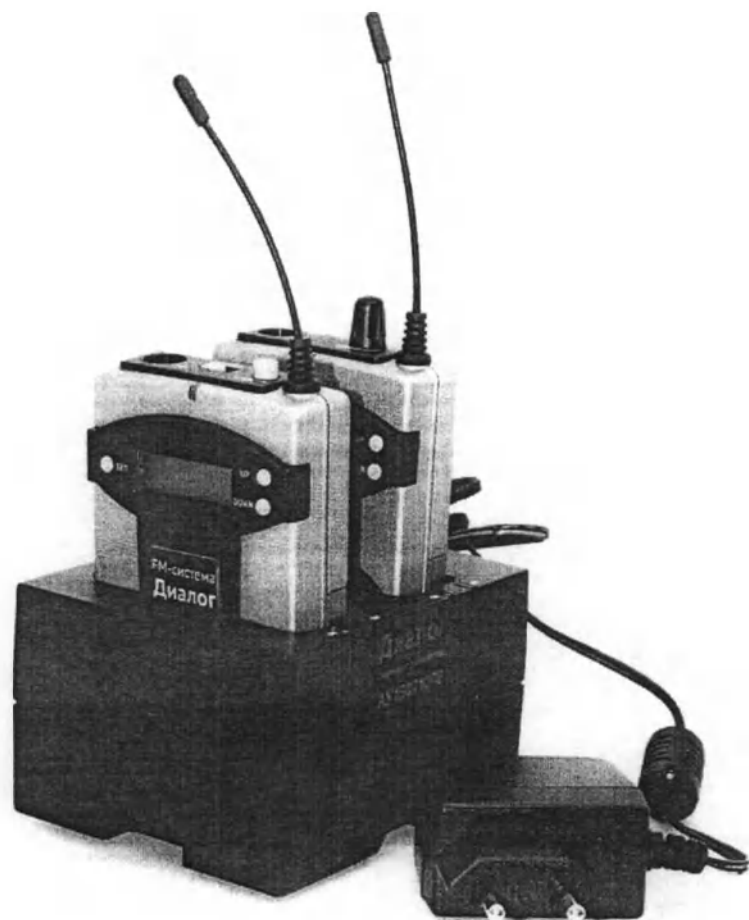

Зарядное устройство для FM-адаптера и FM-передатчика

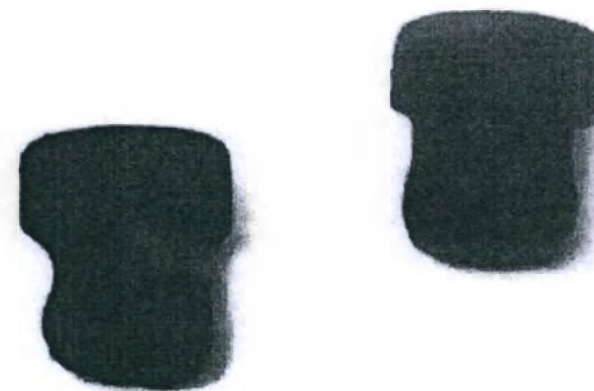

Комплект цветowych маркеров (левый и правый)

Аппарат слуховой электронный разбитацонный воздушного
звукорегулирования цифровой программируемый «Аурика»
«Битва» по ТУ 28.60.14-020-81271212-2017, варианты
исполнения, с комплектностью»

» АУРИКА

Количество: 1 / шт.


РУ № _____

Дата производства/упаковки: 05.10.19

Условия хранения 1 по ГОСТ 15150

Срок службы: 5 лет

Срок сохранности: 2 года

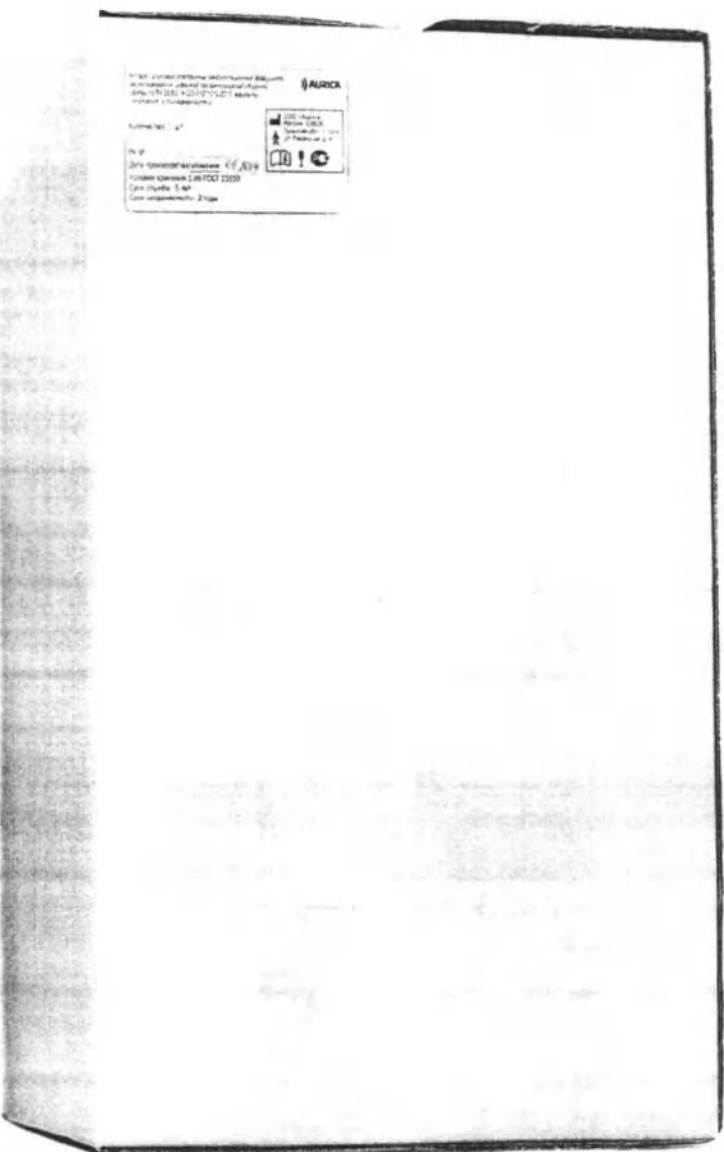

Транспортная упаковка медицинского изделия

Маркировка транспортной упаковки медицинского изделия