



GE Healthcare

123112, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб.
Пресненская, дом 10, помещ. I, этаж 14, ком. 30.

Т 7 495 739 69 31

Ф 7 495 739 6932

ПОДВЕРЖДАЮ

Лидер по регистрации

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

Дорофеева Ю. Н.

2023 года



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Стационарная ангиографическая рентгеновская система Allia IGS 3, Allia IGS 5 с принадлежностями»

«GE Medical Systems SCS»

(«ДжиИ Медикал Системз Эс-Си-Эс»)



Рисунок 1. Стационарная ангиографическая рентгеновская система Allia IGS 5

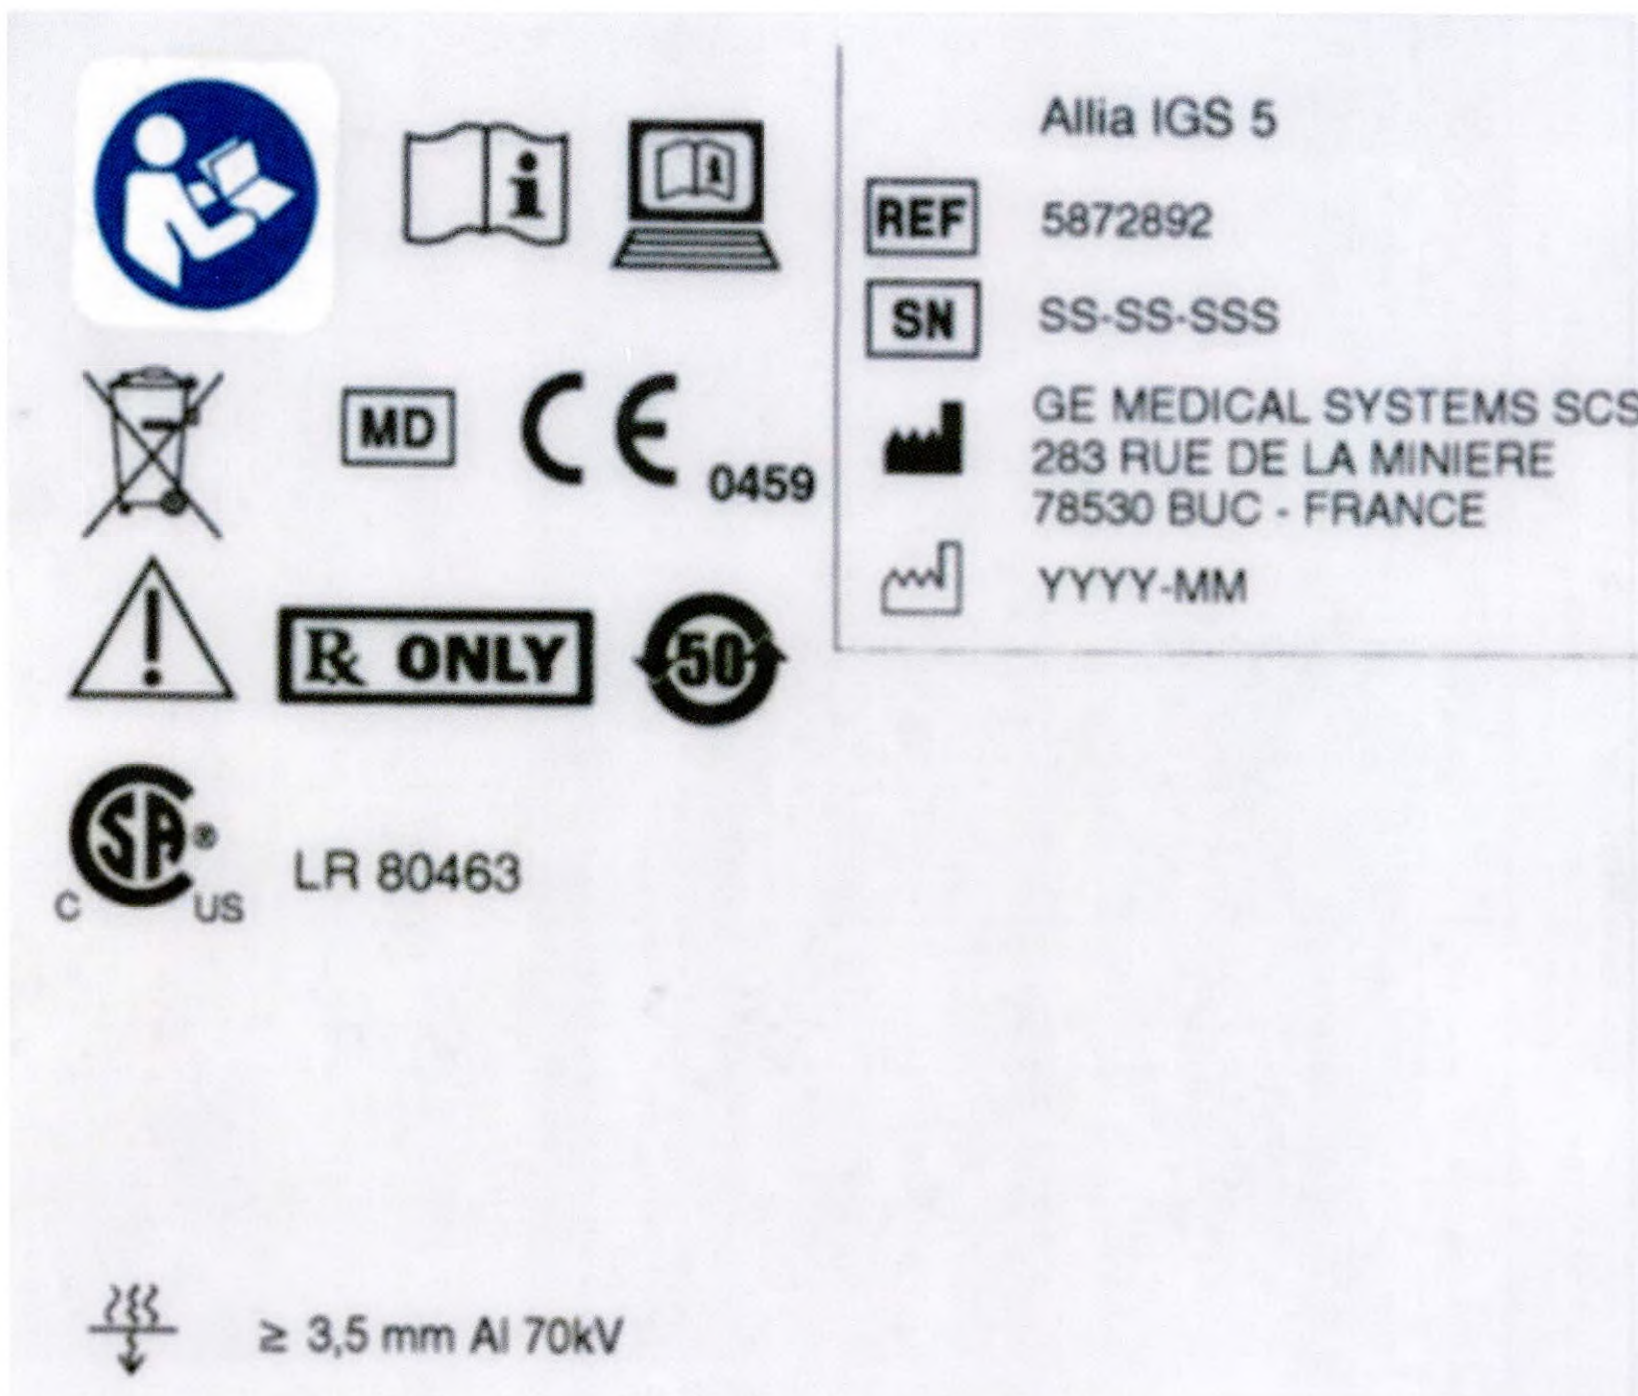


Рисунок 2. Пример маркировки стационарной ангиографической рентгеновской системы Allia IGS 5

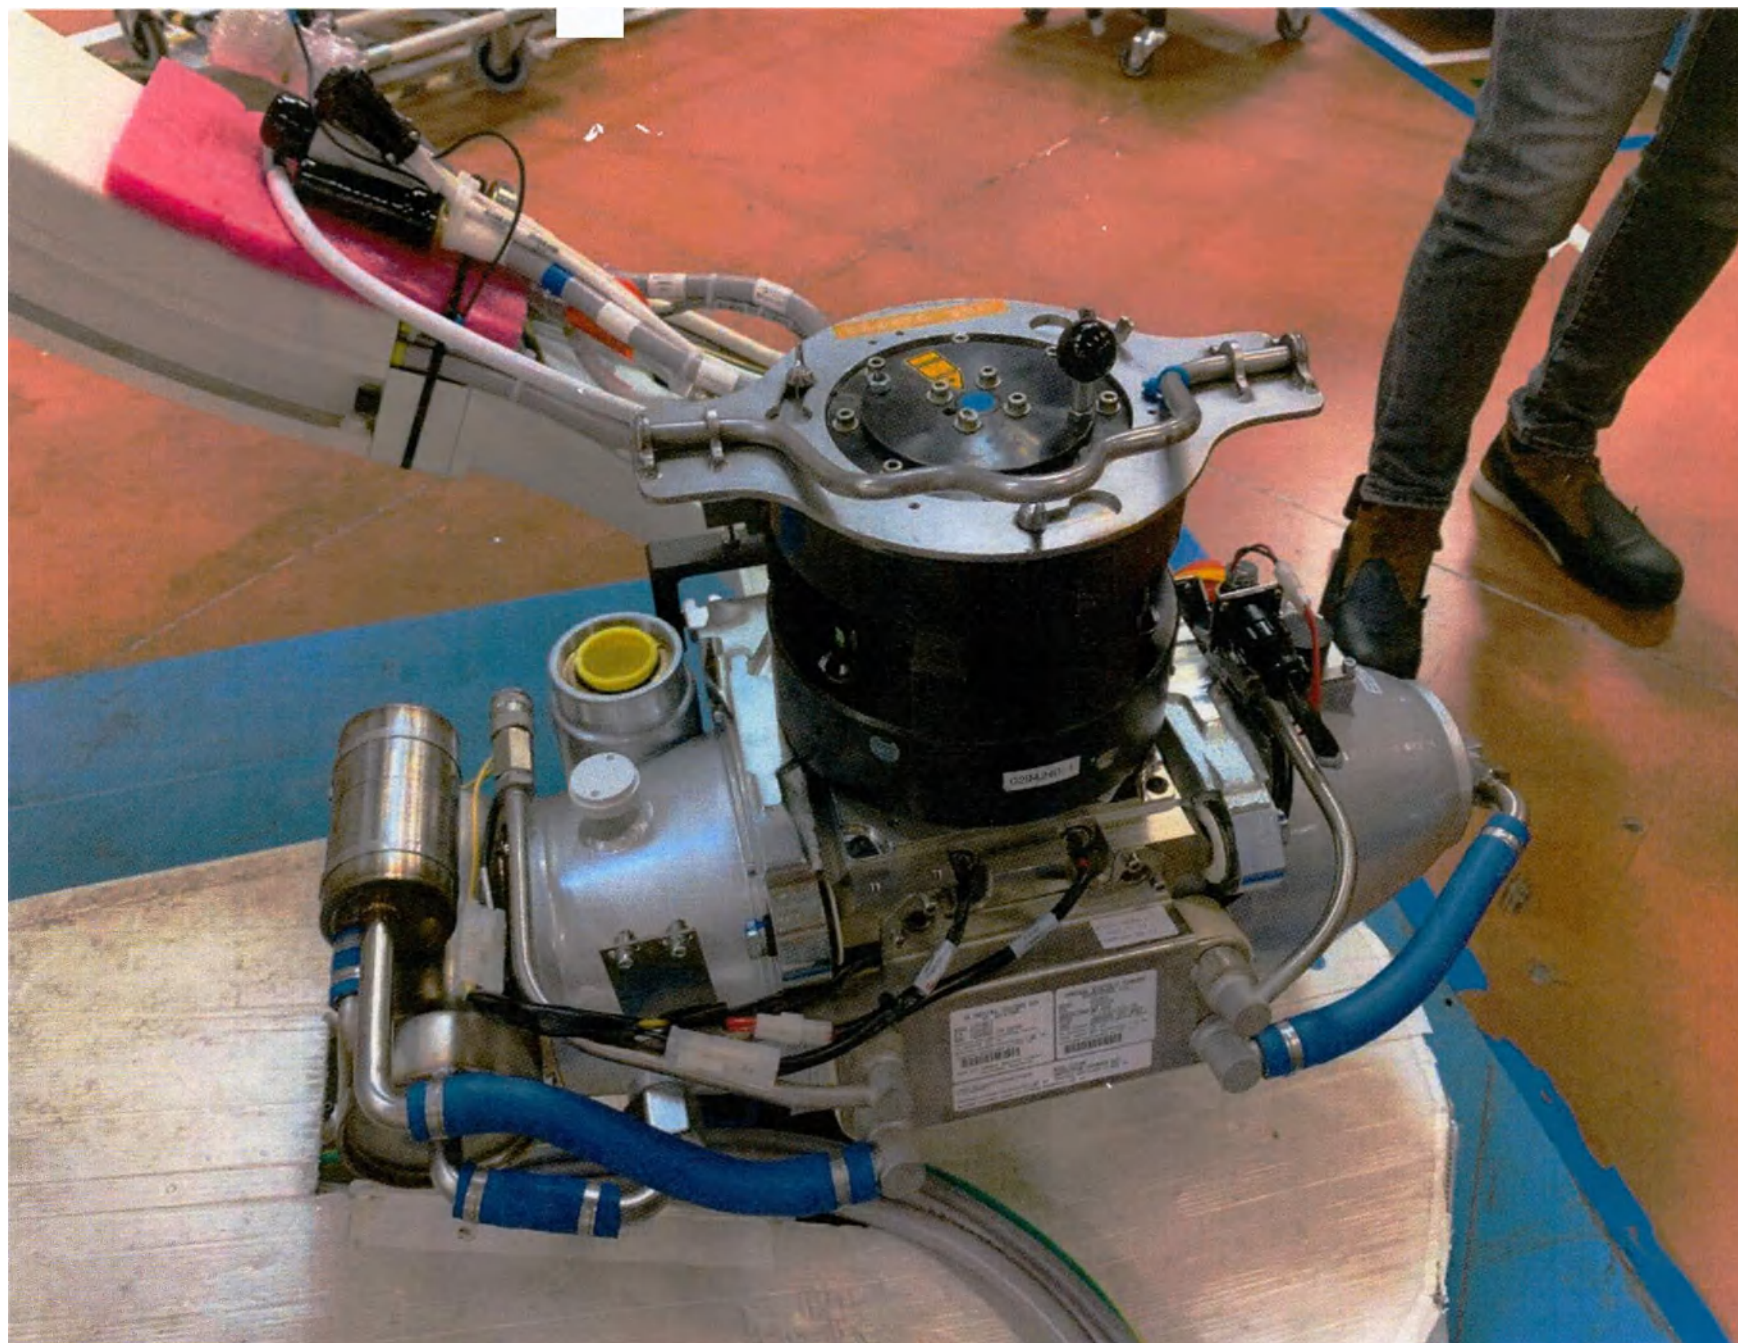


Рисунок 3. Рентгеновская трубка

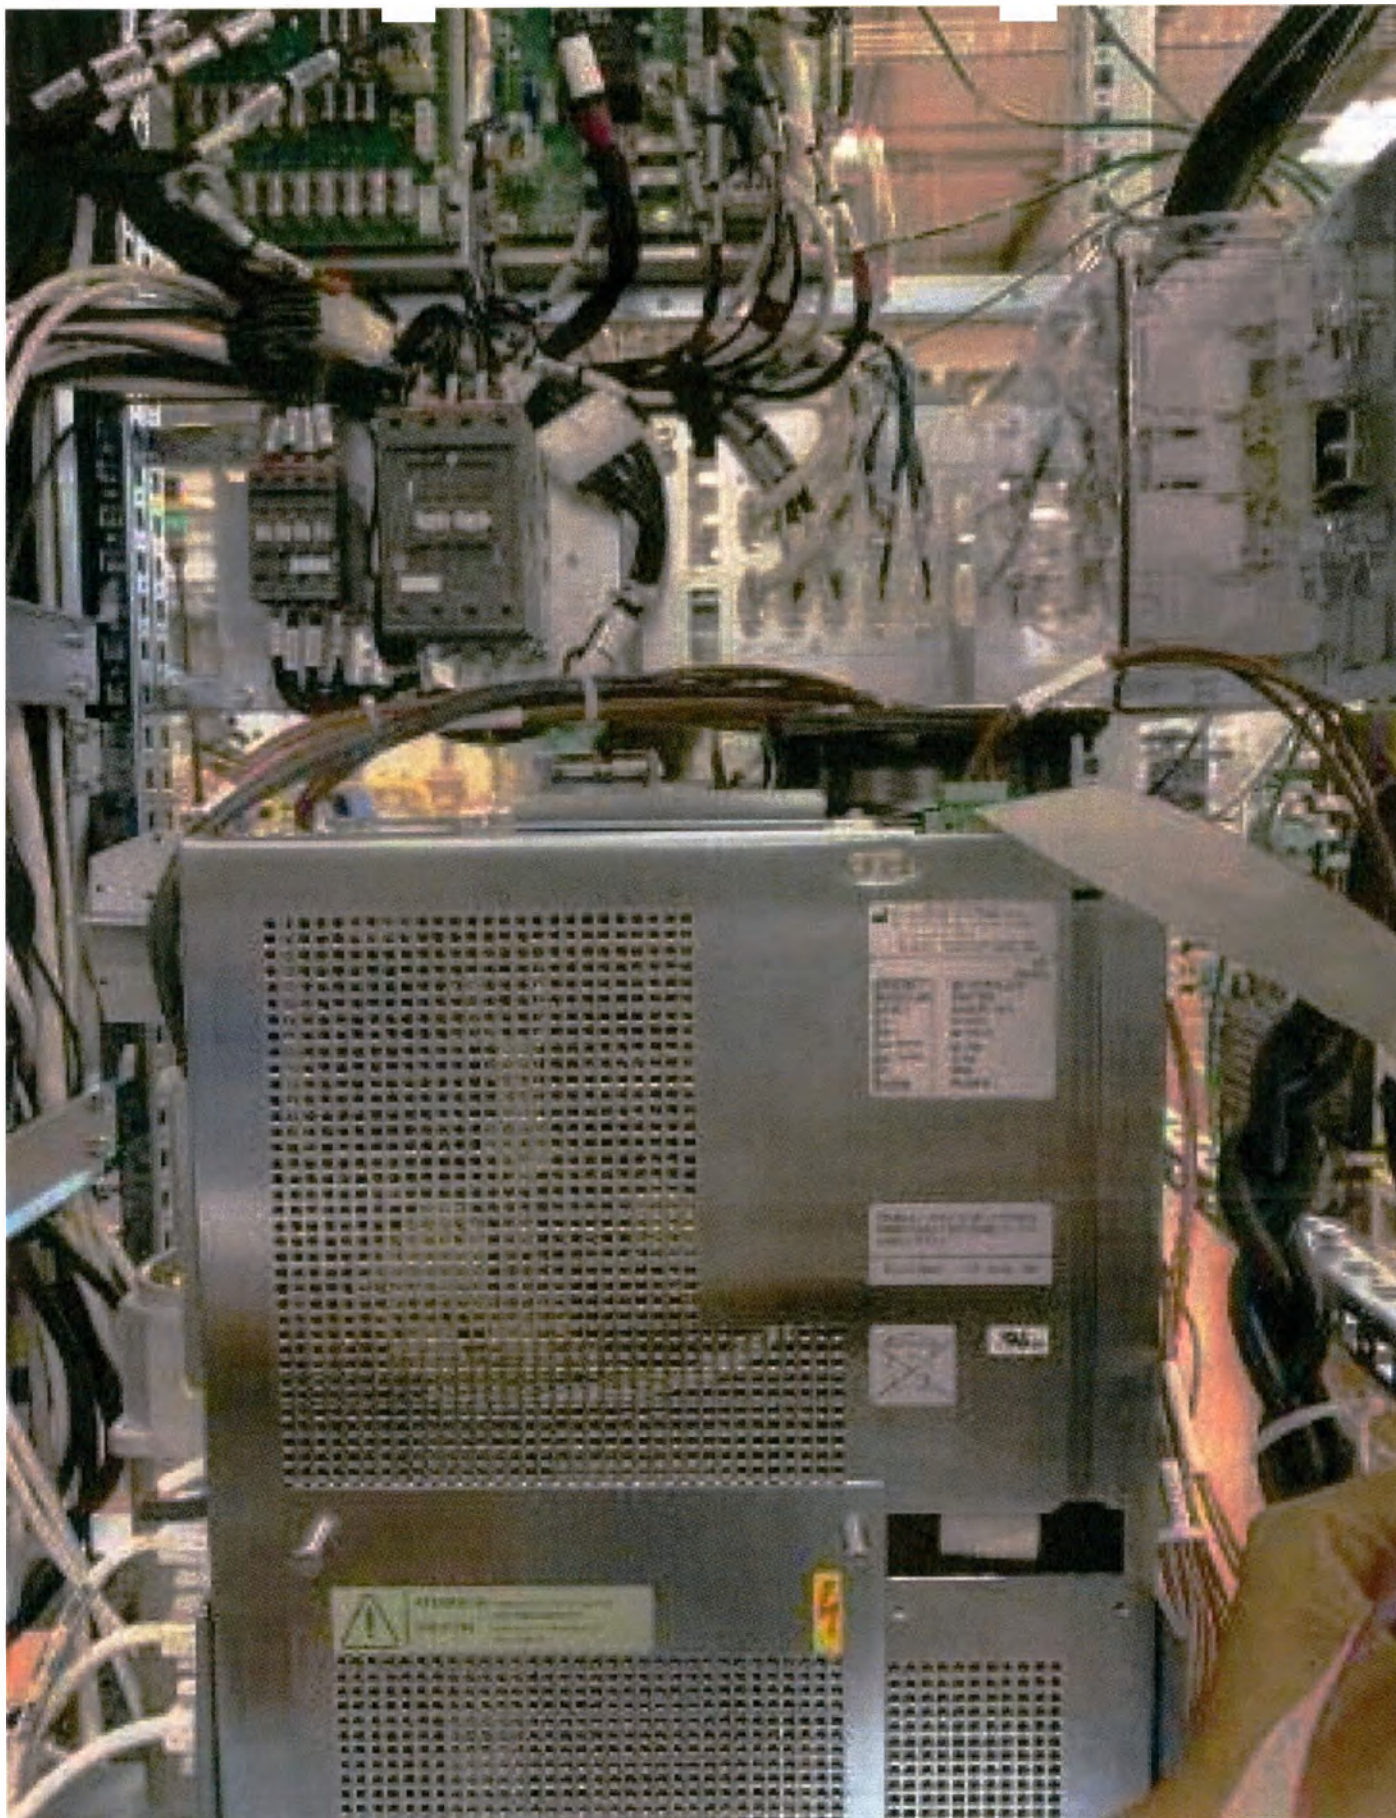


Рисунок 4. Генератор



Рисунок 5. Генератор



Рисунок 6. Позиционирующее LC-устройство

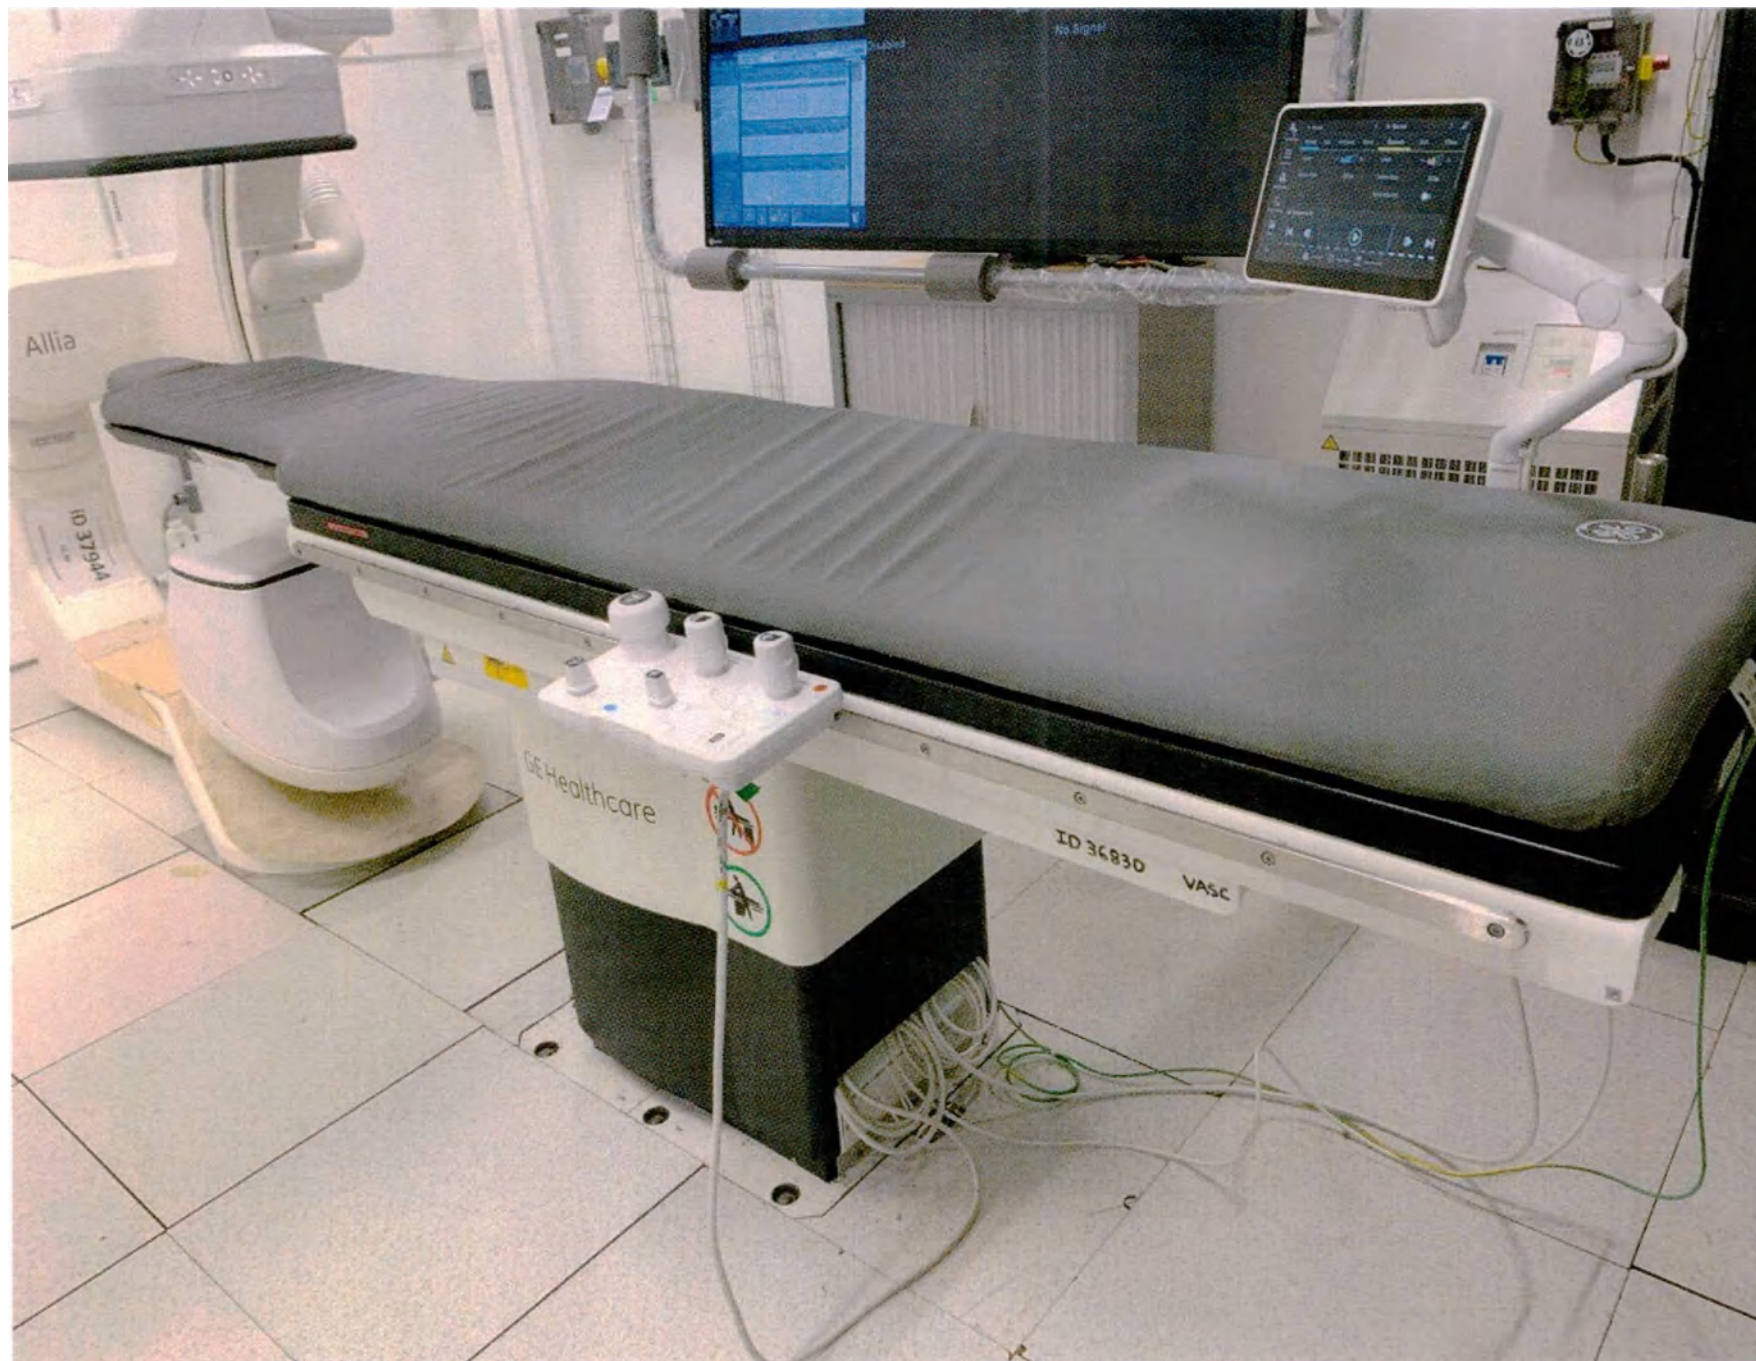


Рисунок 8. Стол ангиографический

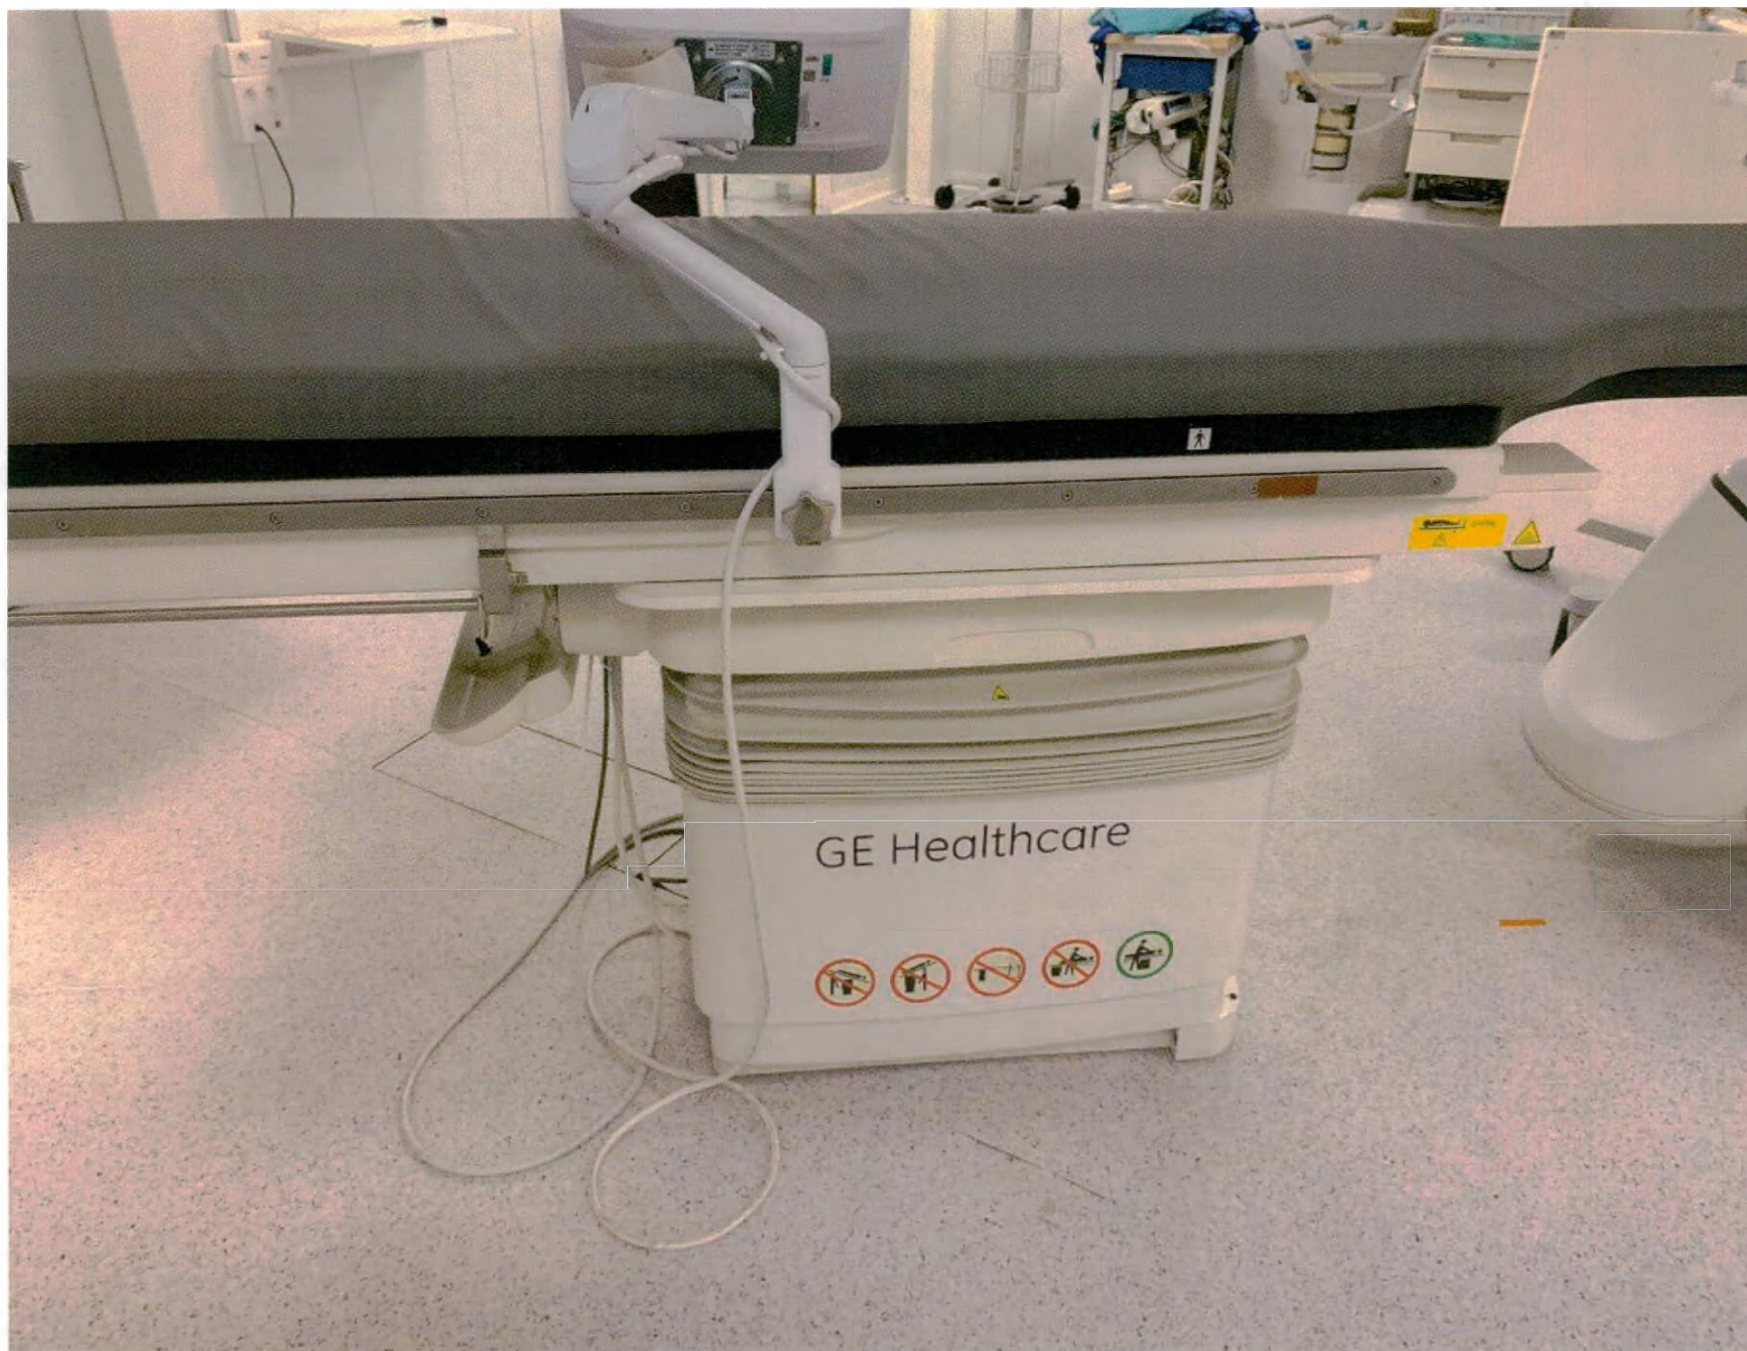


Рисунок 9. Стол ангиографический с опцией наклона



Рисунок 10. Кабели ангиографического стола



Рисунок 11. Система охлаждения цифрового детектора



Рисунок 12. Охлаждающая жидкость



Рисунок 13. Рабочая станция АW для просмотра, обработки и архивации медицинских изображений



Рисунок 14. Кабель для рабочей станции АW

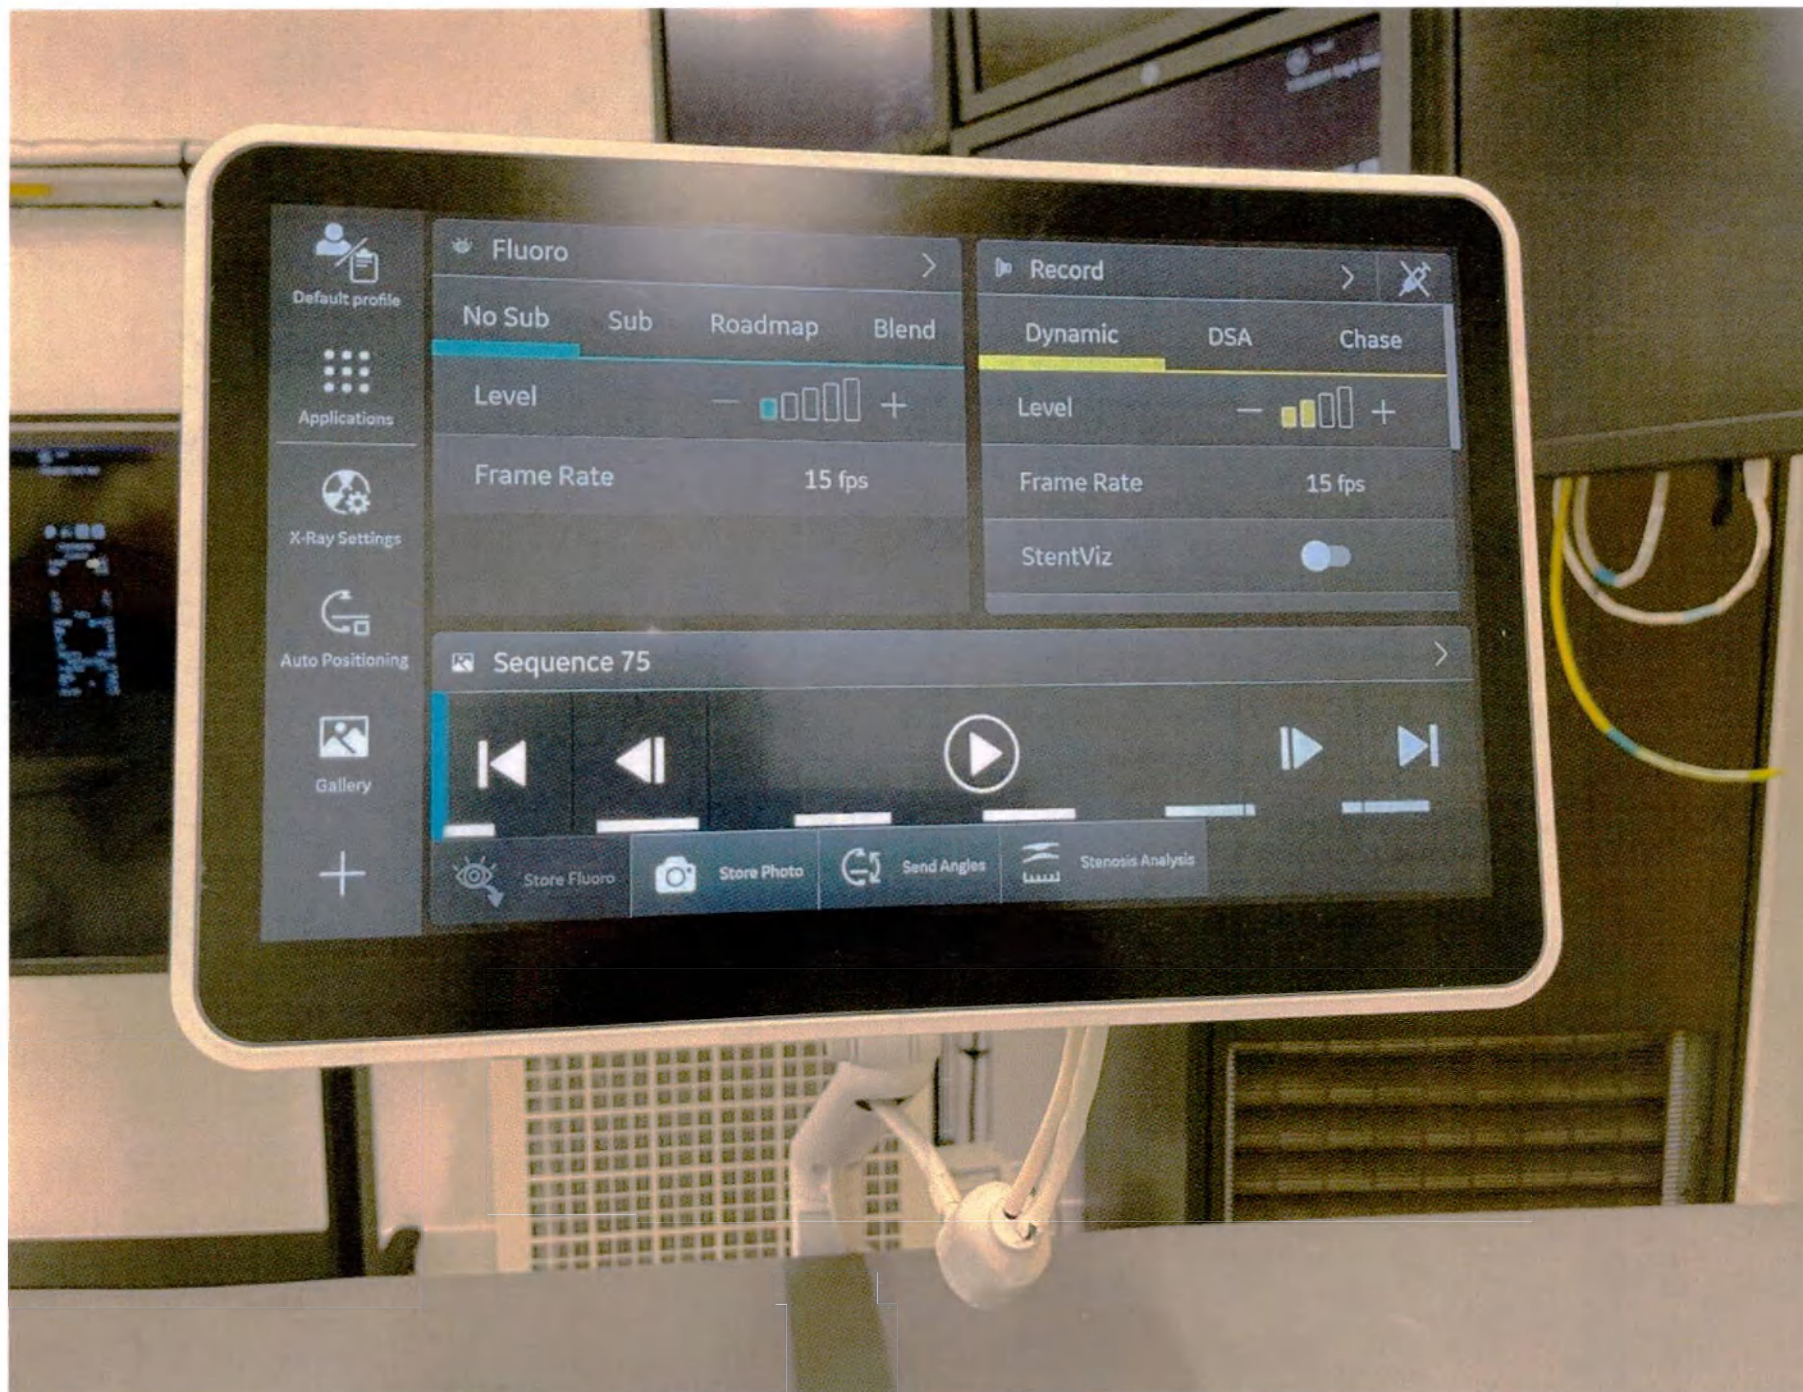


Рисунок 15. Сенсорная панель с элементами крепления



Рисунок 16. Панель управления ангиографической системой

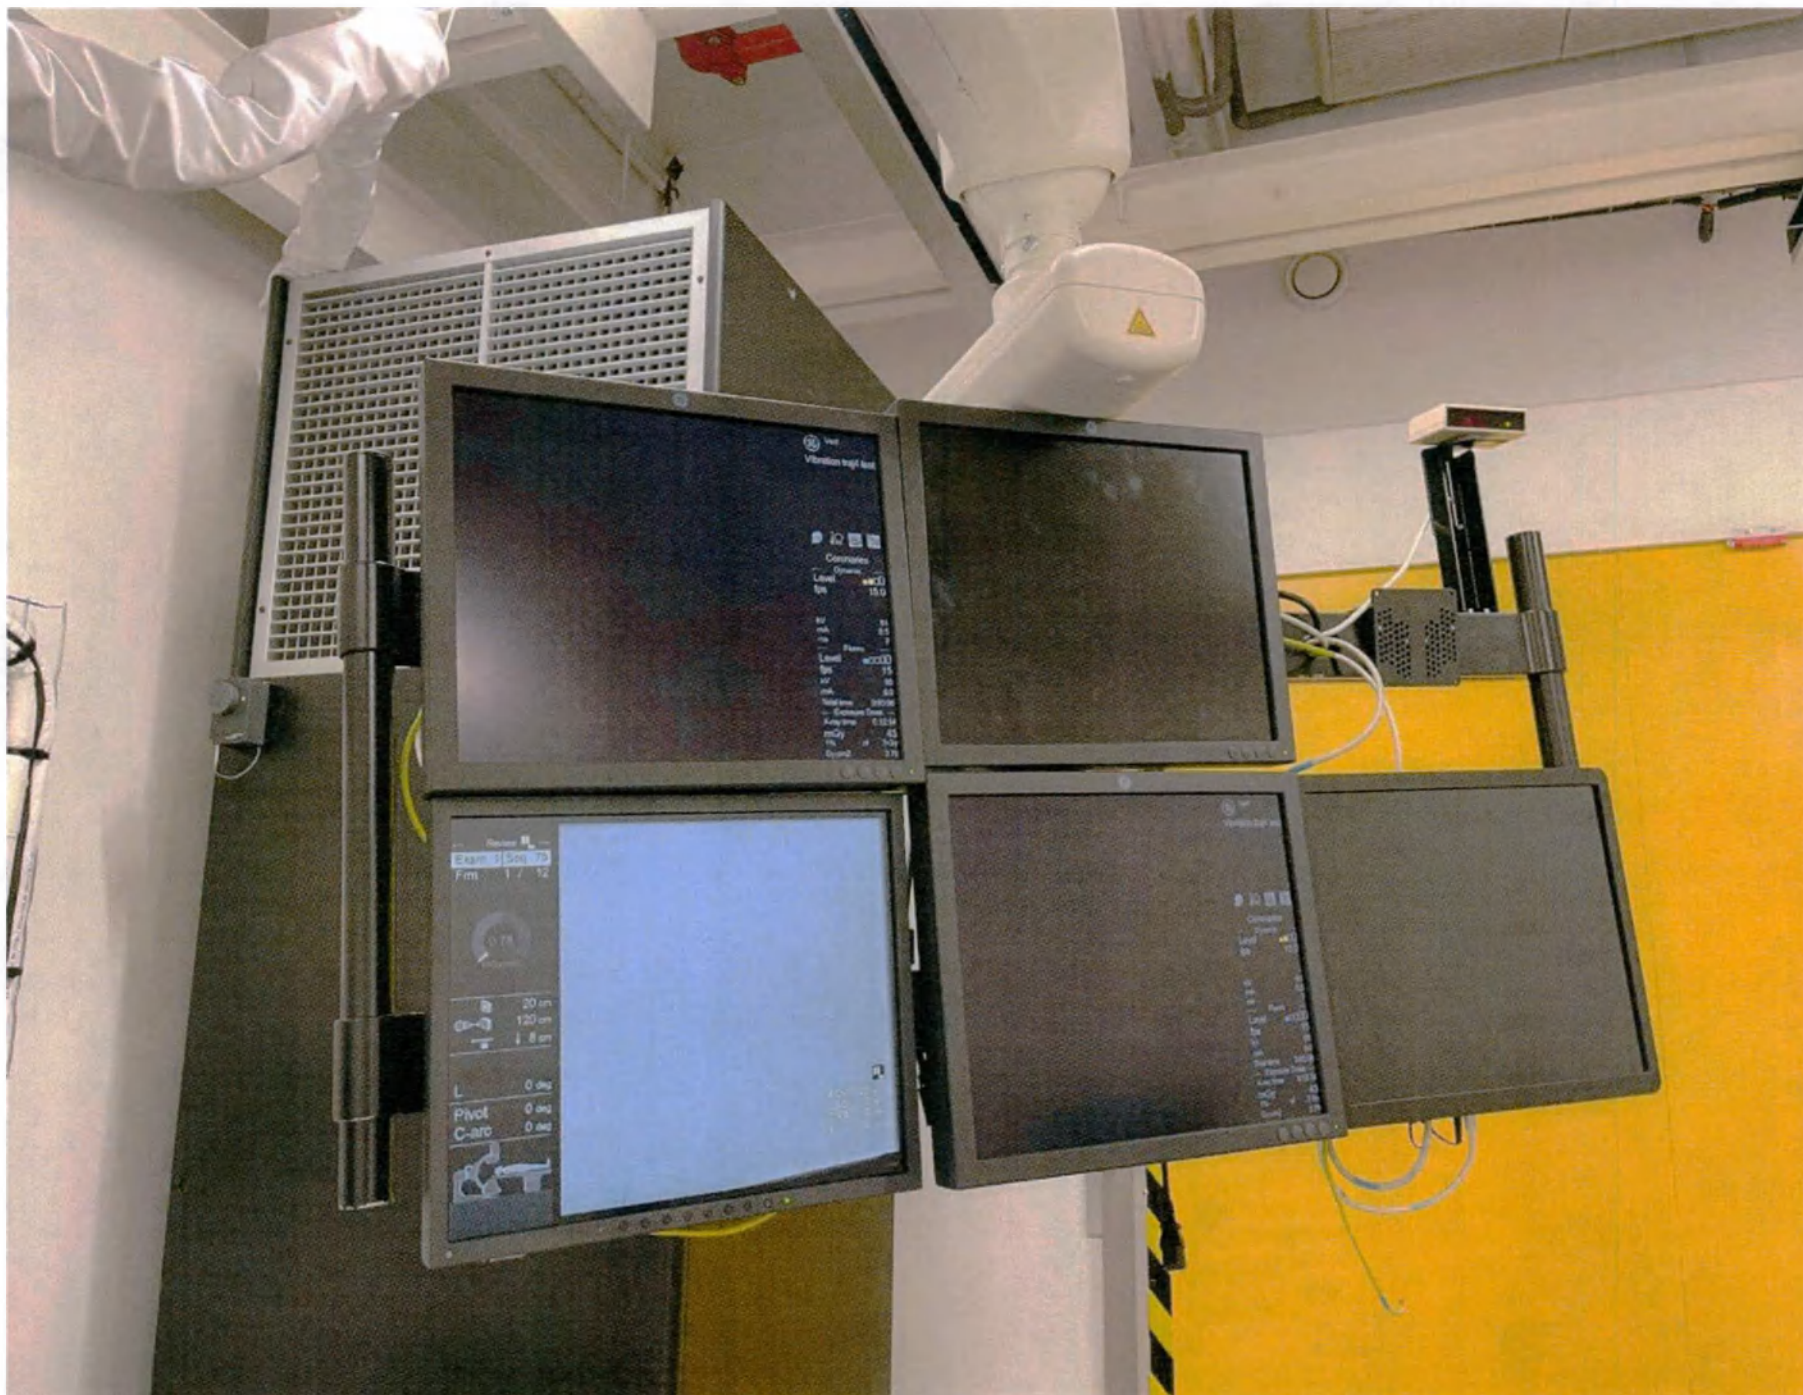


Рисунок 17. Цветные мониторы для вывода мультимодальных изображений

Allia™ IGS 3, Allia™ IGS 5

Руководство оператора

CE

ВНИМАНИЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ, КОТОРЫЙ МОЖНО КОПИРОВАТЬ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬ БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ КОМПАНИИ GE. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ СИСТЕМУ НА ДРУГОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ПОДСТАВКА. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ СИСТЕМУ НА ДРУГОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ПОДСТАВКА. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ СИСТЕМУ НА ДРУГОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ПОДСТАВКА. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ СИСТЕМУ НА ДРУГОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ПОДСТАВКА.



Model: IGS
Type: IGS
Serial: IGS
Date of Issue: IGS
Date of Revision: IGS

Рисунок 18. Документация пользователя

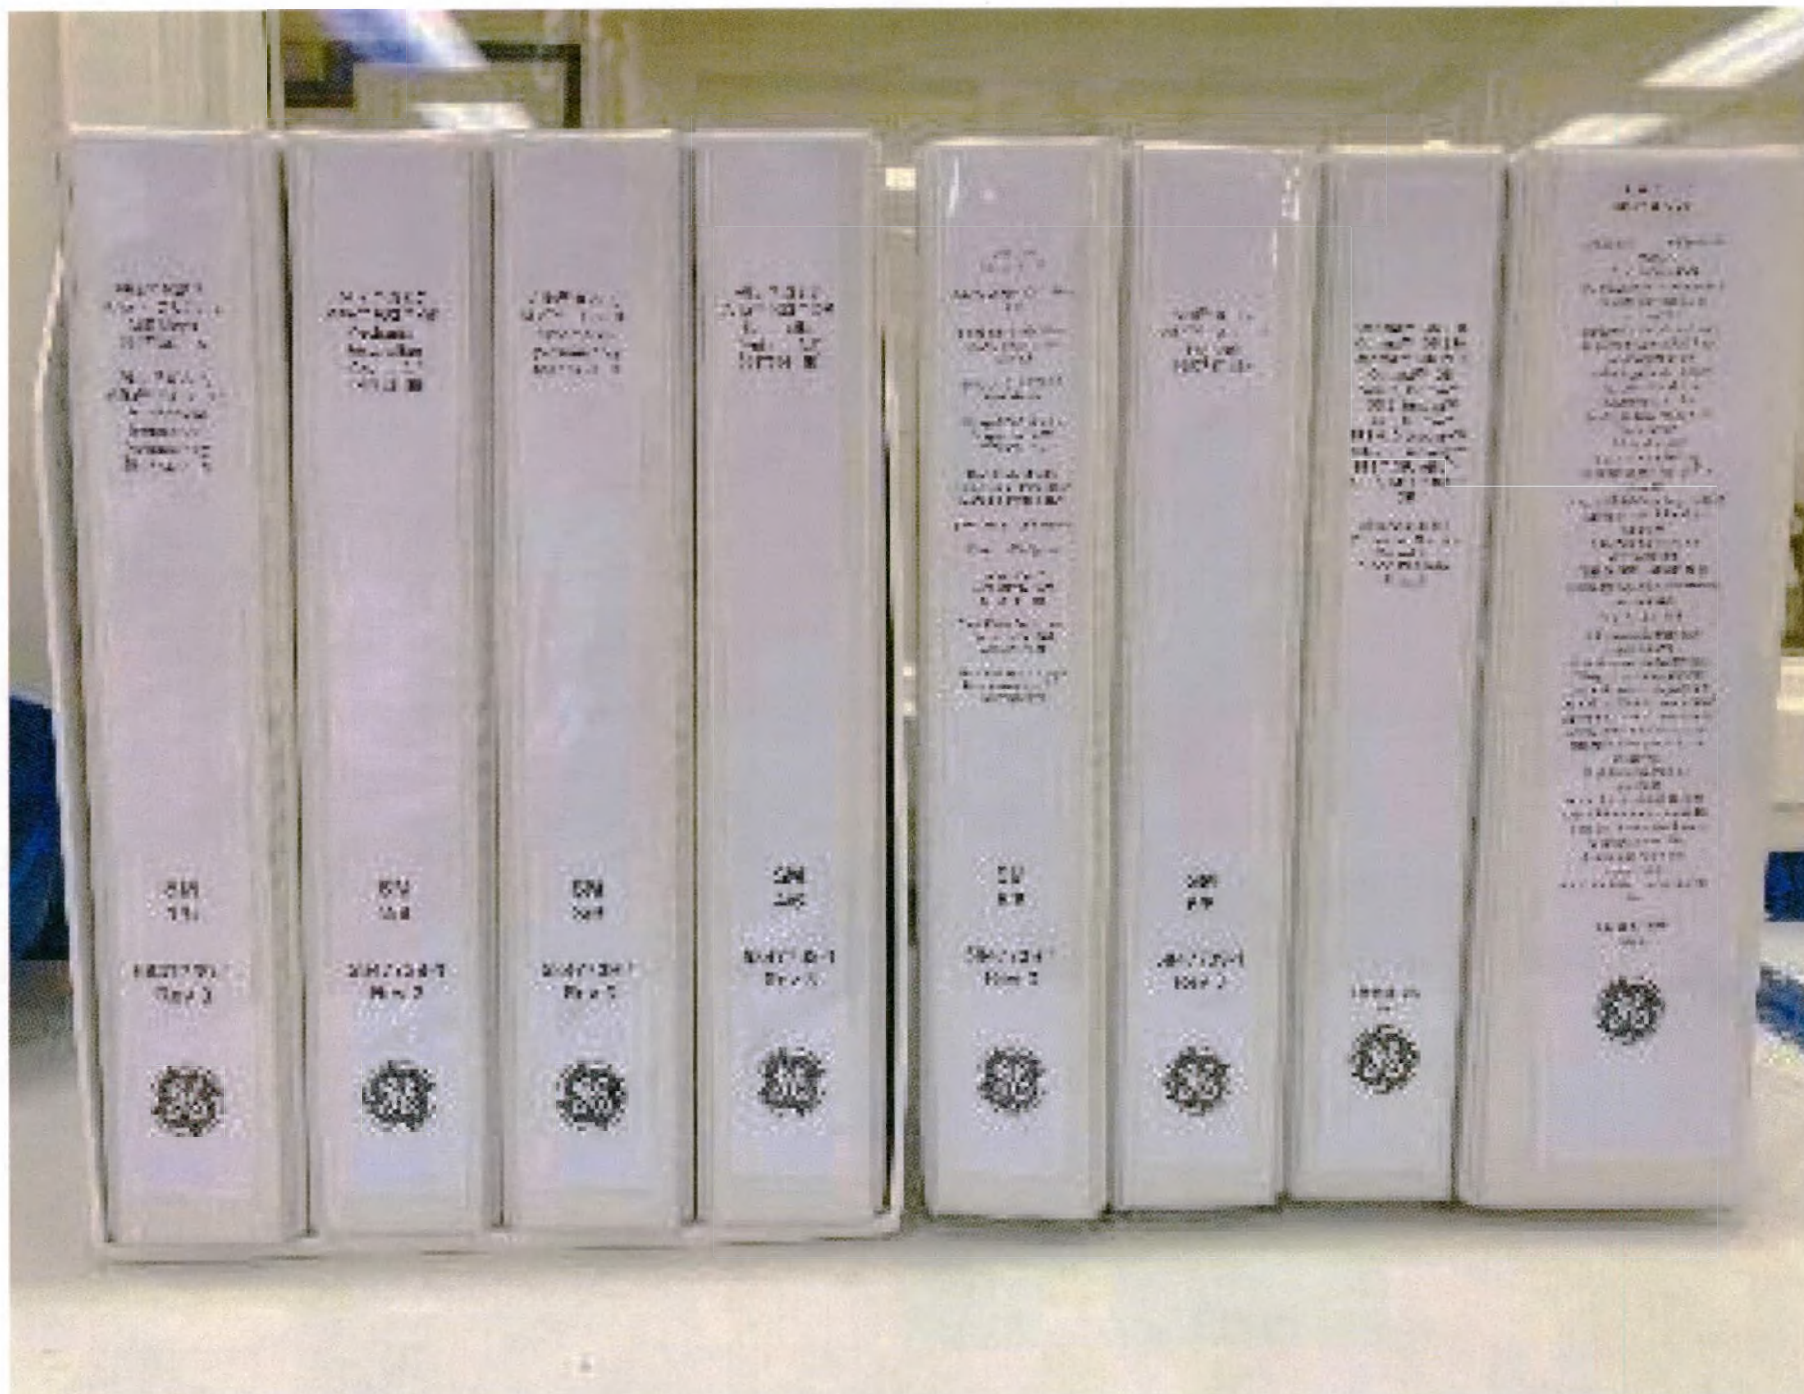


Рисунок 19. Документация техническая



Рисунок 20. Монитор пациента CARESCAPE B450 – РУ № РЗН 2016/3956



Рисунок 21. Источник бесперебойного питания



Рисунок 23. Медицинские мониторы для вывода живого и референсного изображения



Рисунок 22. Распределительный щит для источника бесперебойного питания



Рисунок 24. Система гемодинамического мониторинга Mac-Lab, РУ № РЗН 2016/4274



Рисунок 25. Система электрофизиологического мониторинга CardioLab РУ № РЗН 2016/4273



Рисунок 26. Система комбинированного электрофизиологического и гемодинамического мониторинга ComboLab РУ № РЗН 2016/4283



Рисунок 27. Дополнительная рукоятка позиционирования стола



Рисунок 28. Рельсовый расширитель для ножного конца стола



Рисунок 29. Устройства обслуживания стола ангиографического

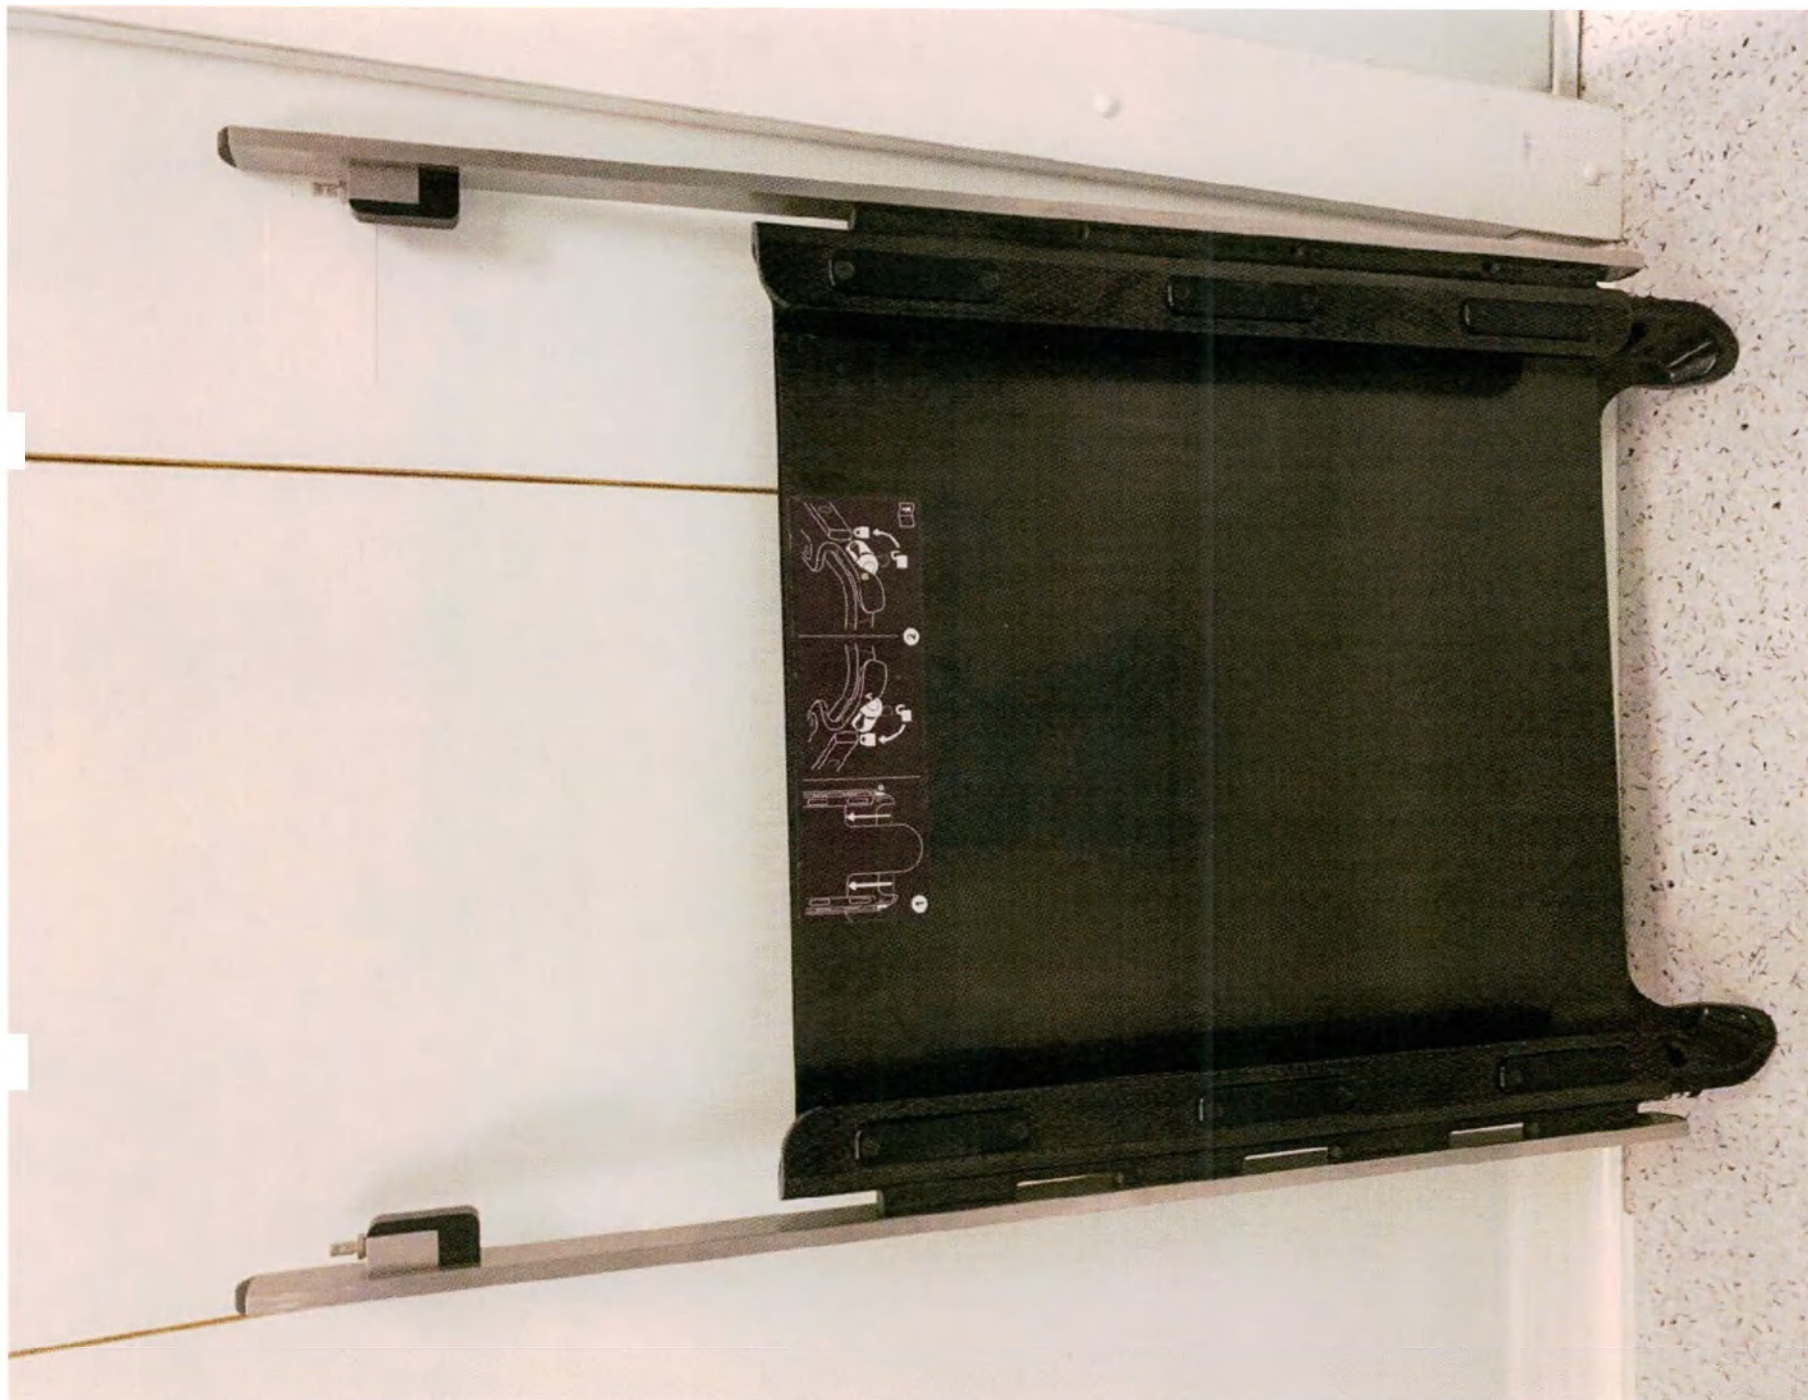


Рисунок 30. Рельсы для

подвесного оборудования для стола



Рисунок 31. Устройства для подготовки к установке системы



Рисунок 32. Кабели для монтажа системы

GEHC proprietary



Рисунок 33. Кабель для видео соединения ангиографической системы с системой гемодинамического мониторинга



Рисунок 34. Беспроводной педальный переключатель



Рисунок 35. Проводной педальный переключатель.



Рисунок 36. Панель управления позиционером



Рисунок 37. Удаленная панель управления ангиографической системой



Рисунок 38. Удаленная панель управления ангиографической системой



Рисунок 39. Интерфейс для подключения сторонних источников изображения к монитору в процедурной



Рисунок 40. Подвески для крепления мониторов в процедурной с потолочным креплением



Рисунок 41. Подголовник - удлинитель для стола ангиографического

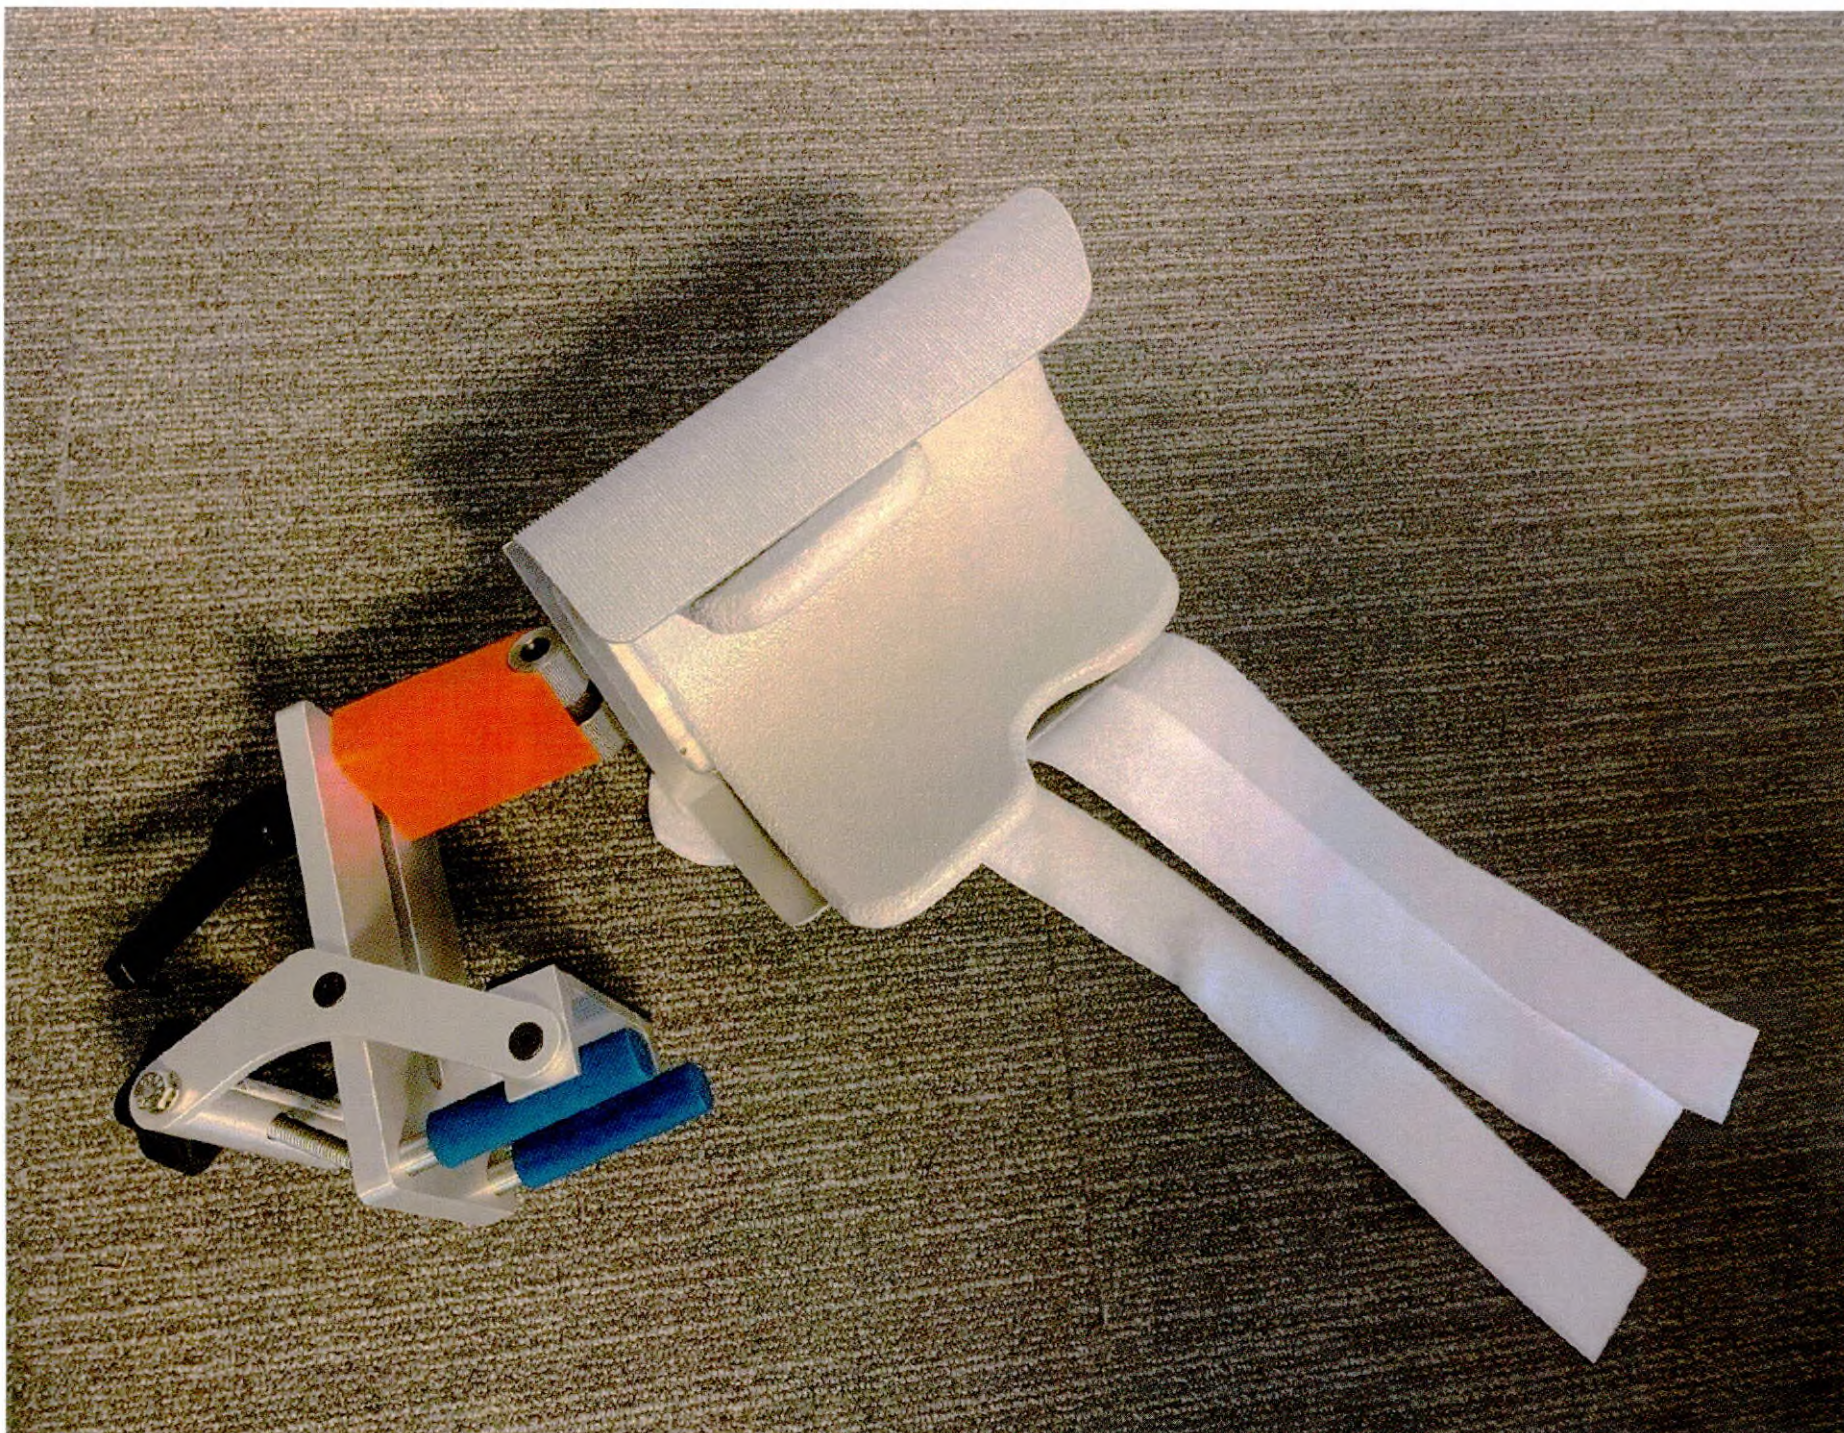


Рисунок 42. Подголовник для исследования сосудов



Рисунок 43. Подкладки для подголовника

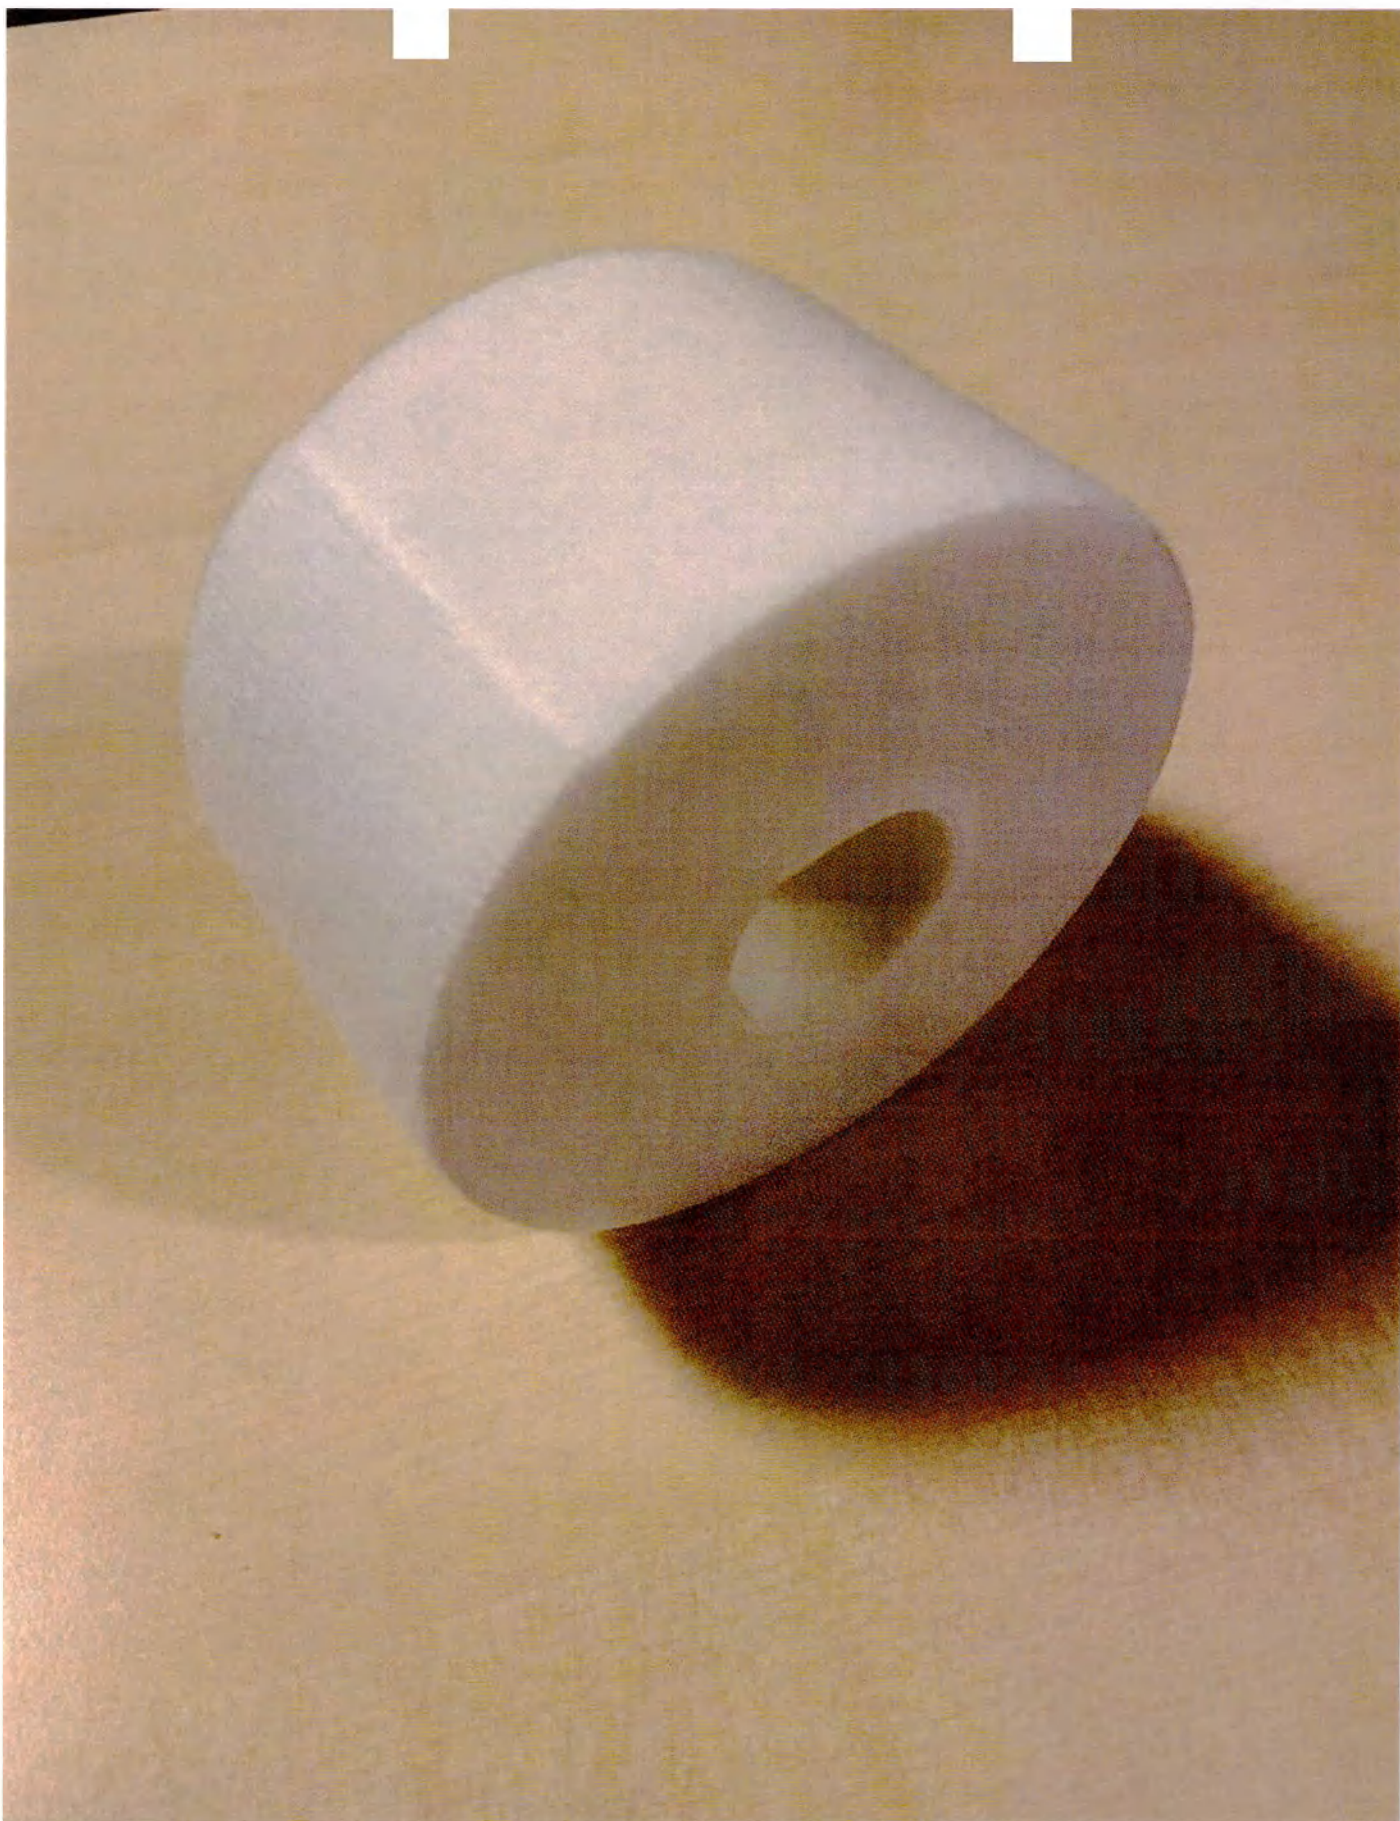


Рисунок 44. Ремни для фиксации пациента

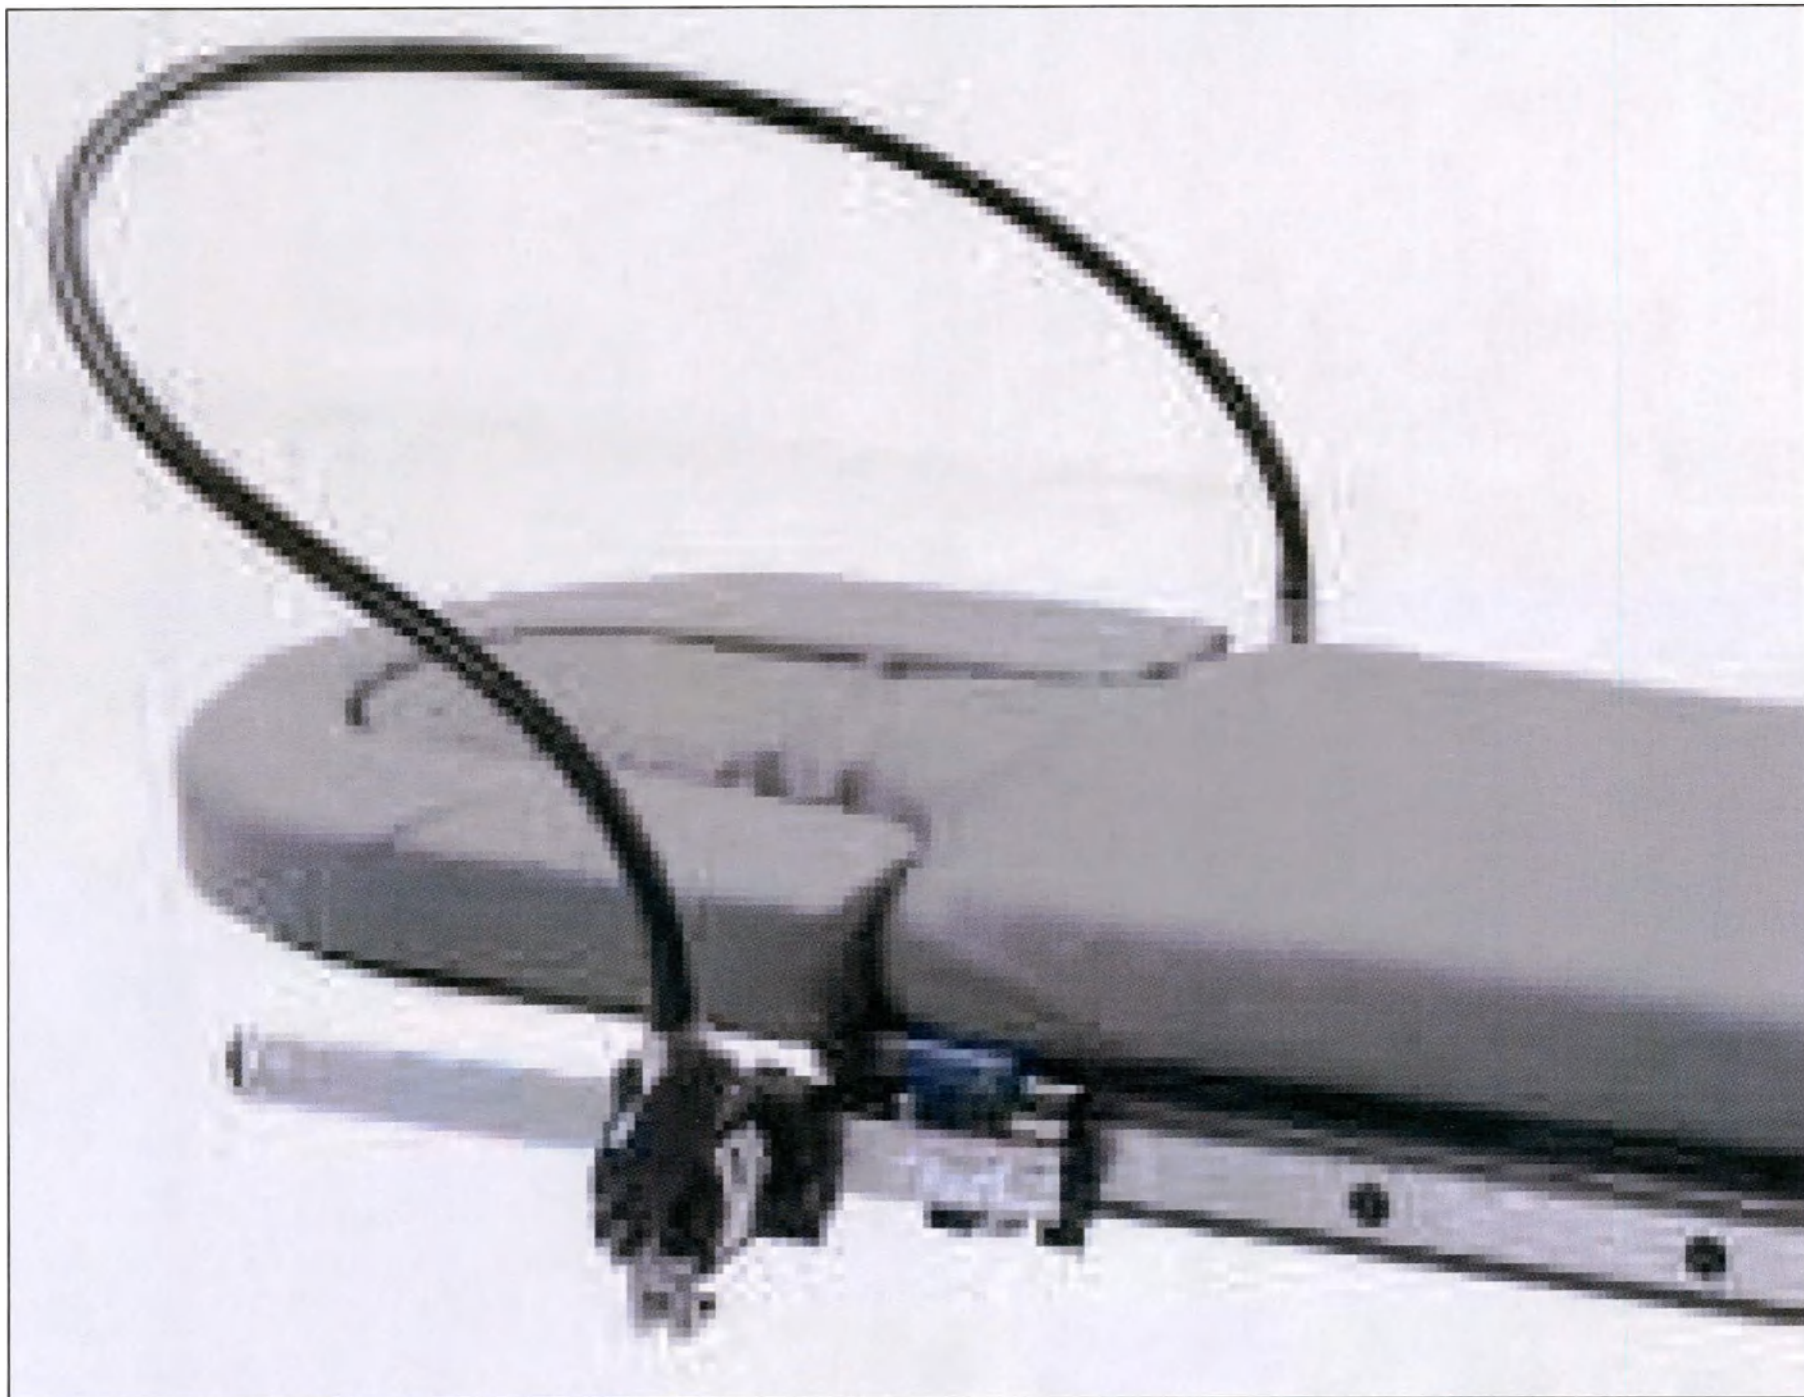


Рисунок 45. Держатель анестезиологического монитора



Рисунок 46. Ограничитель для рук



Рисунок 47. Подлокотники для ангиографического стола с накладкой



Рисунок 48. Расширитель для стола

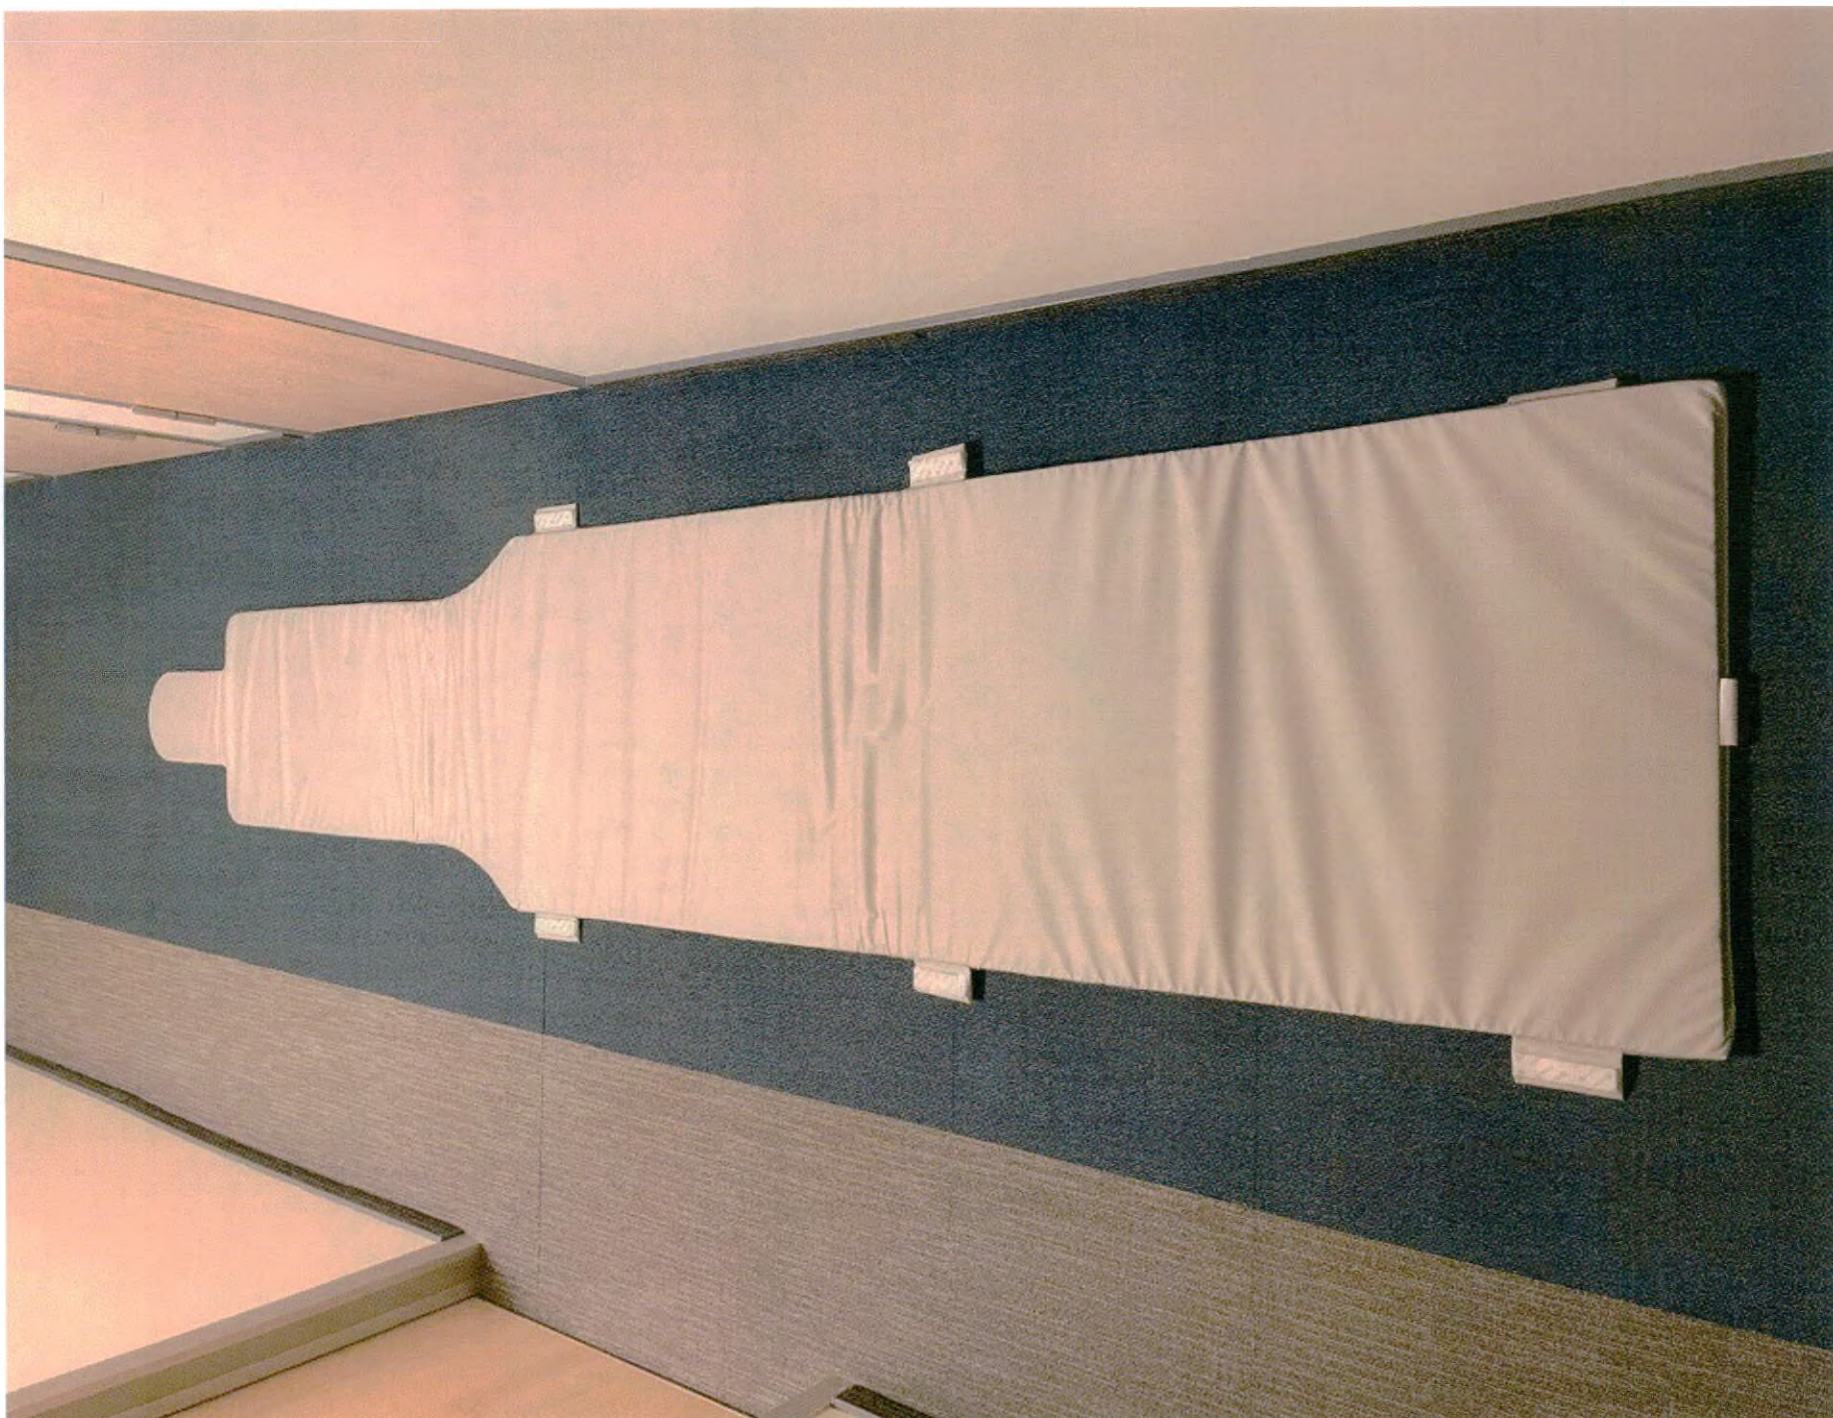


Рисунок 49. Матрас против пролежней



Рисунок 50. Стойка с опорой для внутривенных инъекций



Рисунок 51. Дозиметр



Рисунок 52. Принтер дозиметра



Рисунок 53. Устройство для индикации дозы облучения

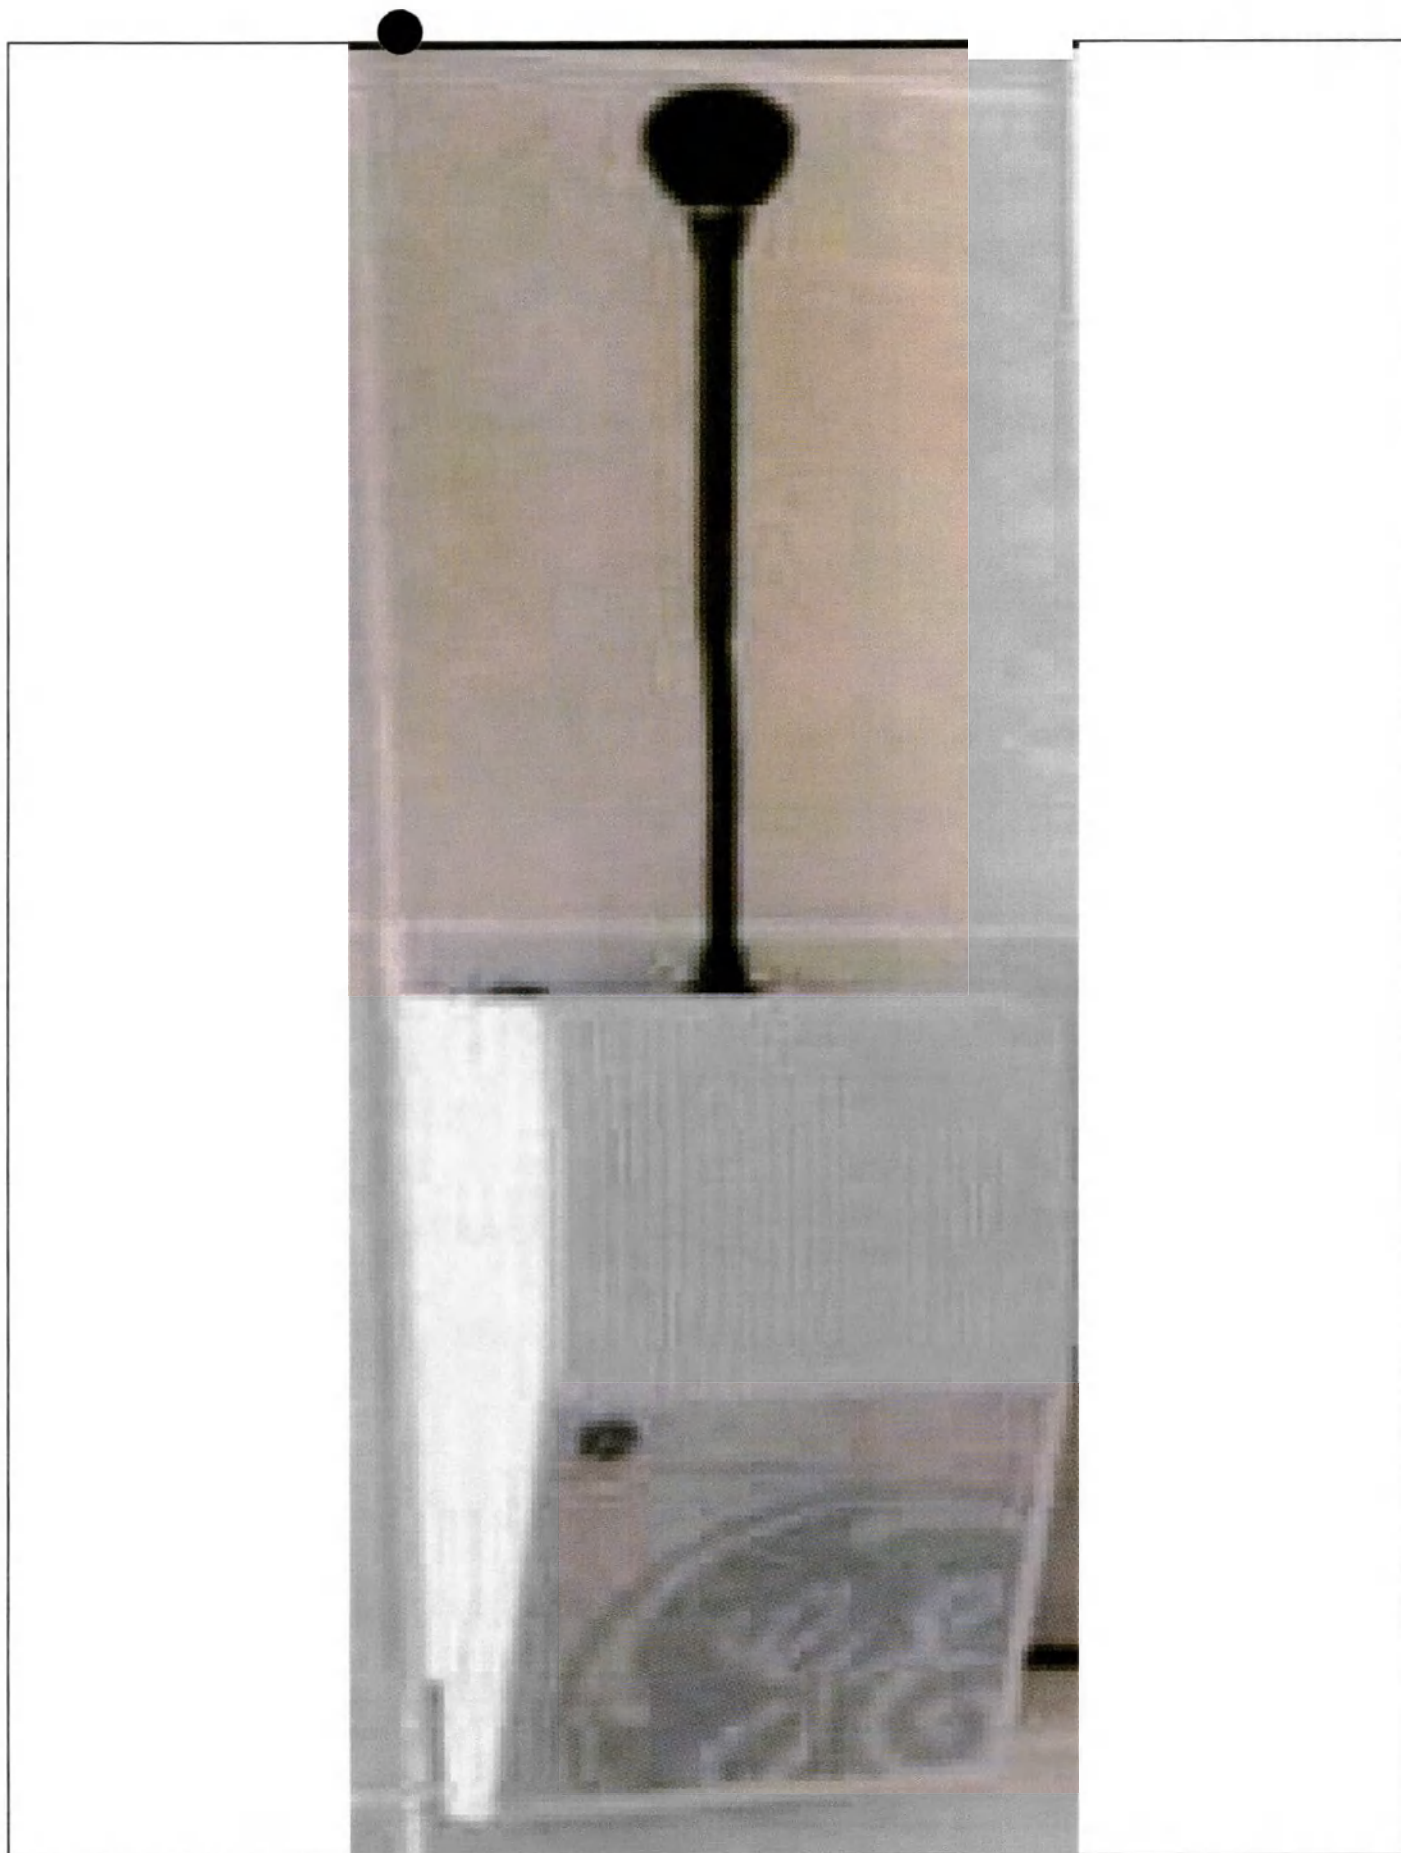


Рисунок 54. Переговорное устройство



Рисунок 55. Программное обеспечение защиты от столкновения с пациентом



Рисунок 56. Бесконтактная система защиты от столкновений с пациентом

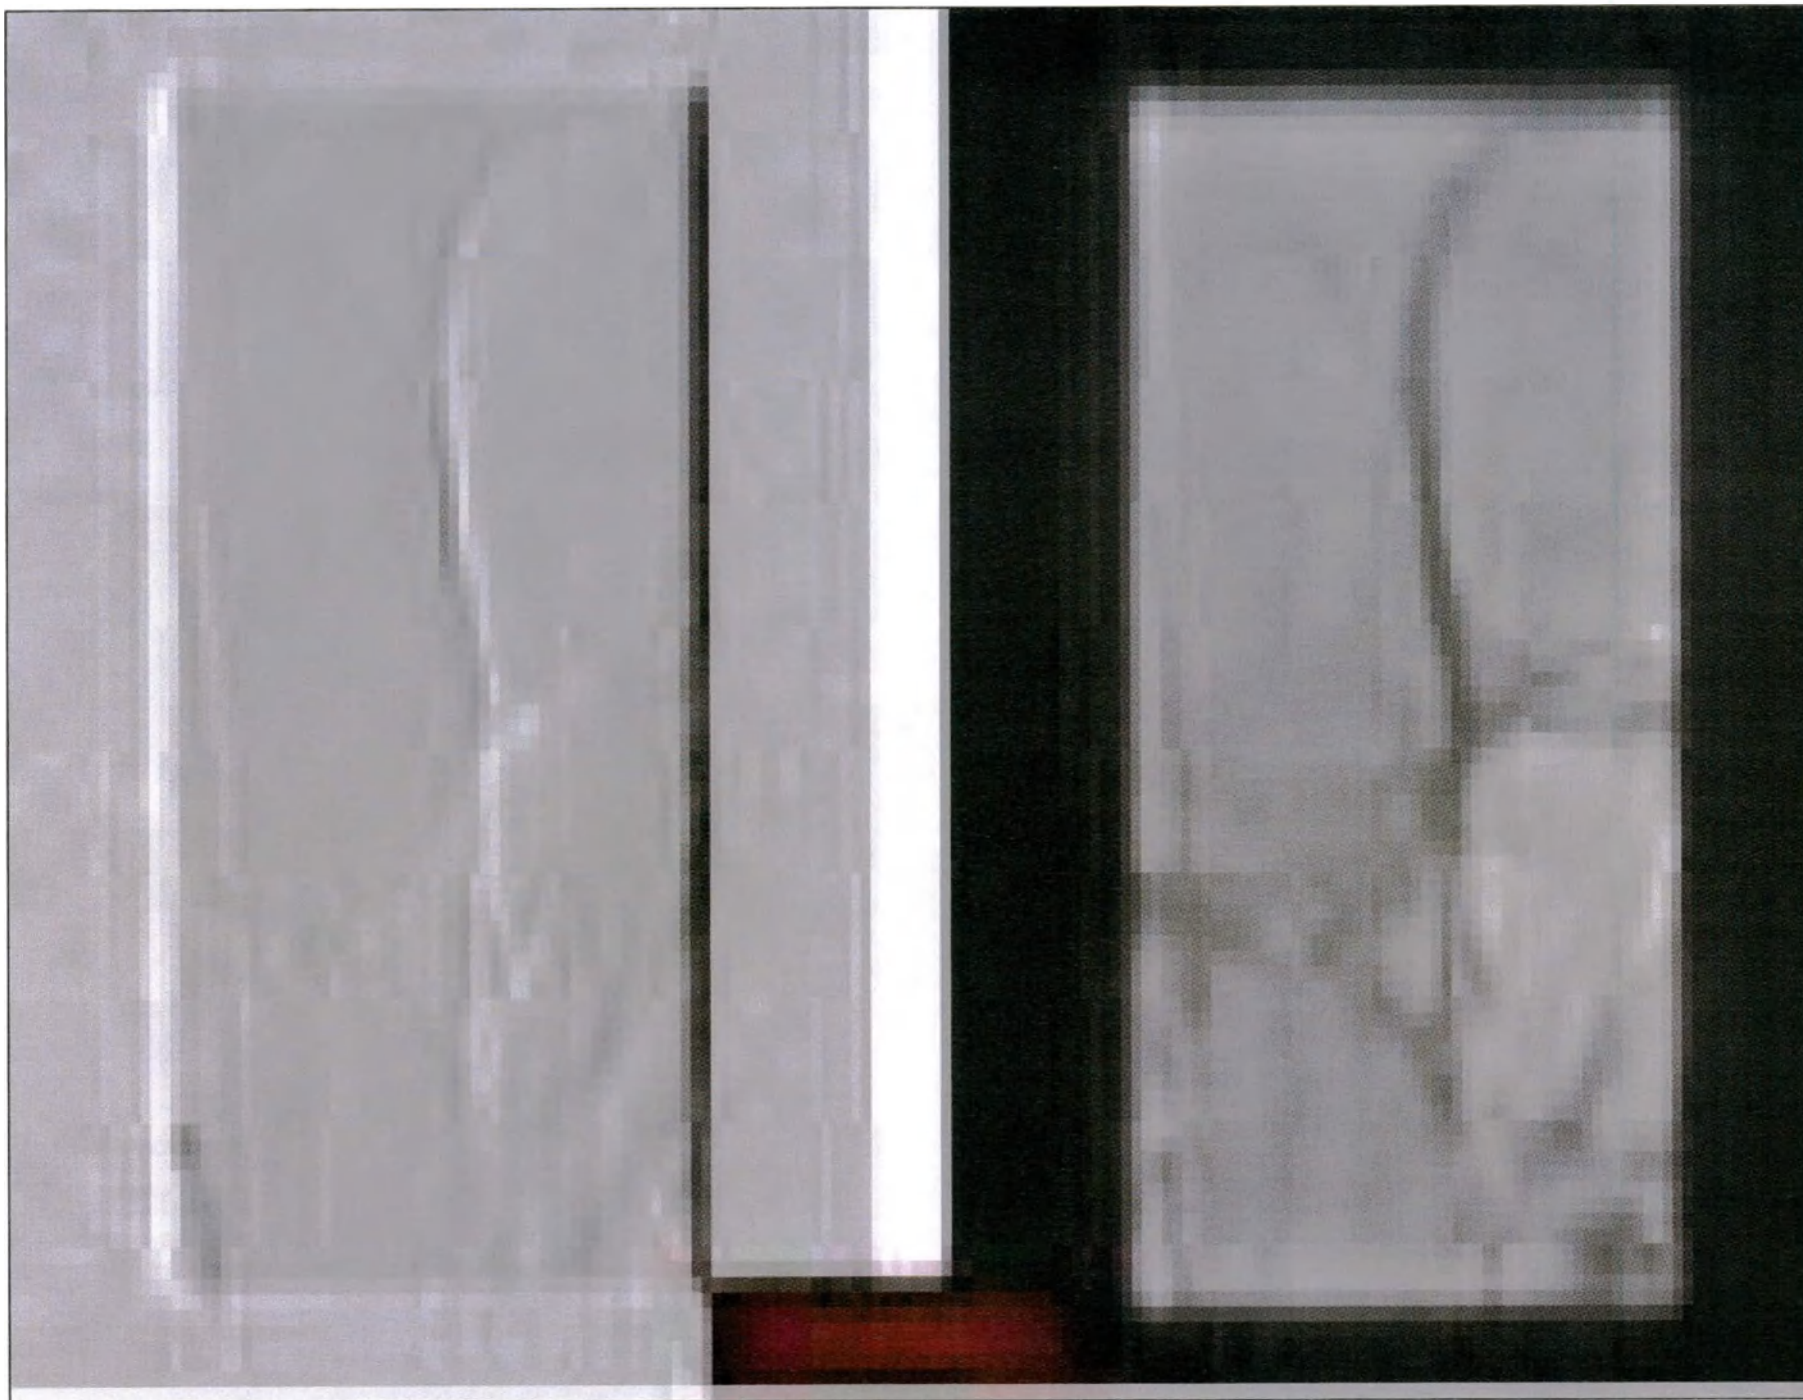


Рисунок 57. Модуль одновременного отображения субтрагированных и несубтрагированных изображений

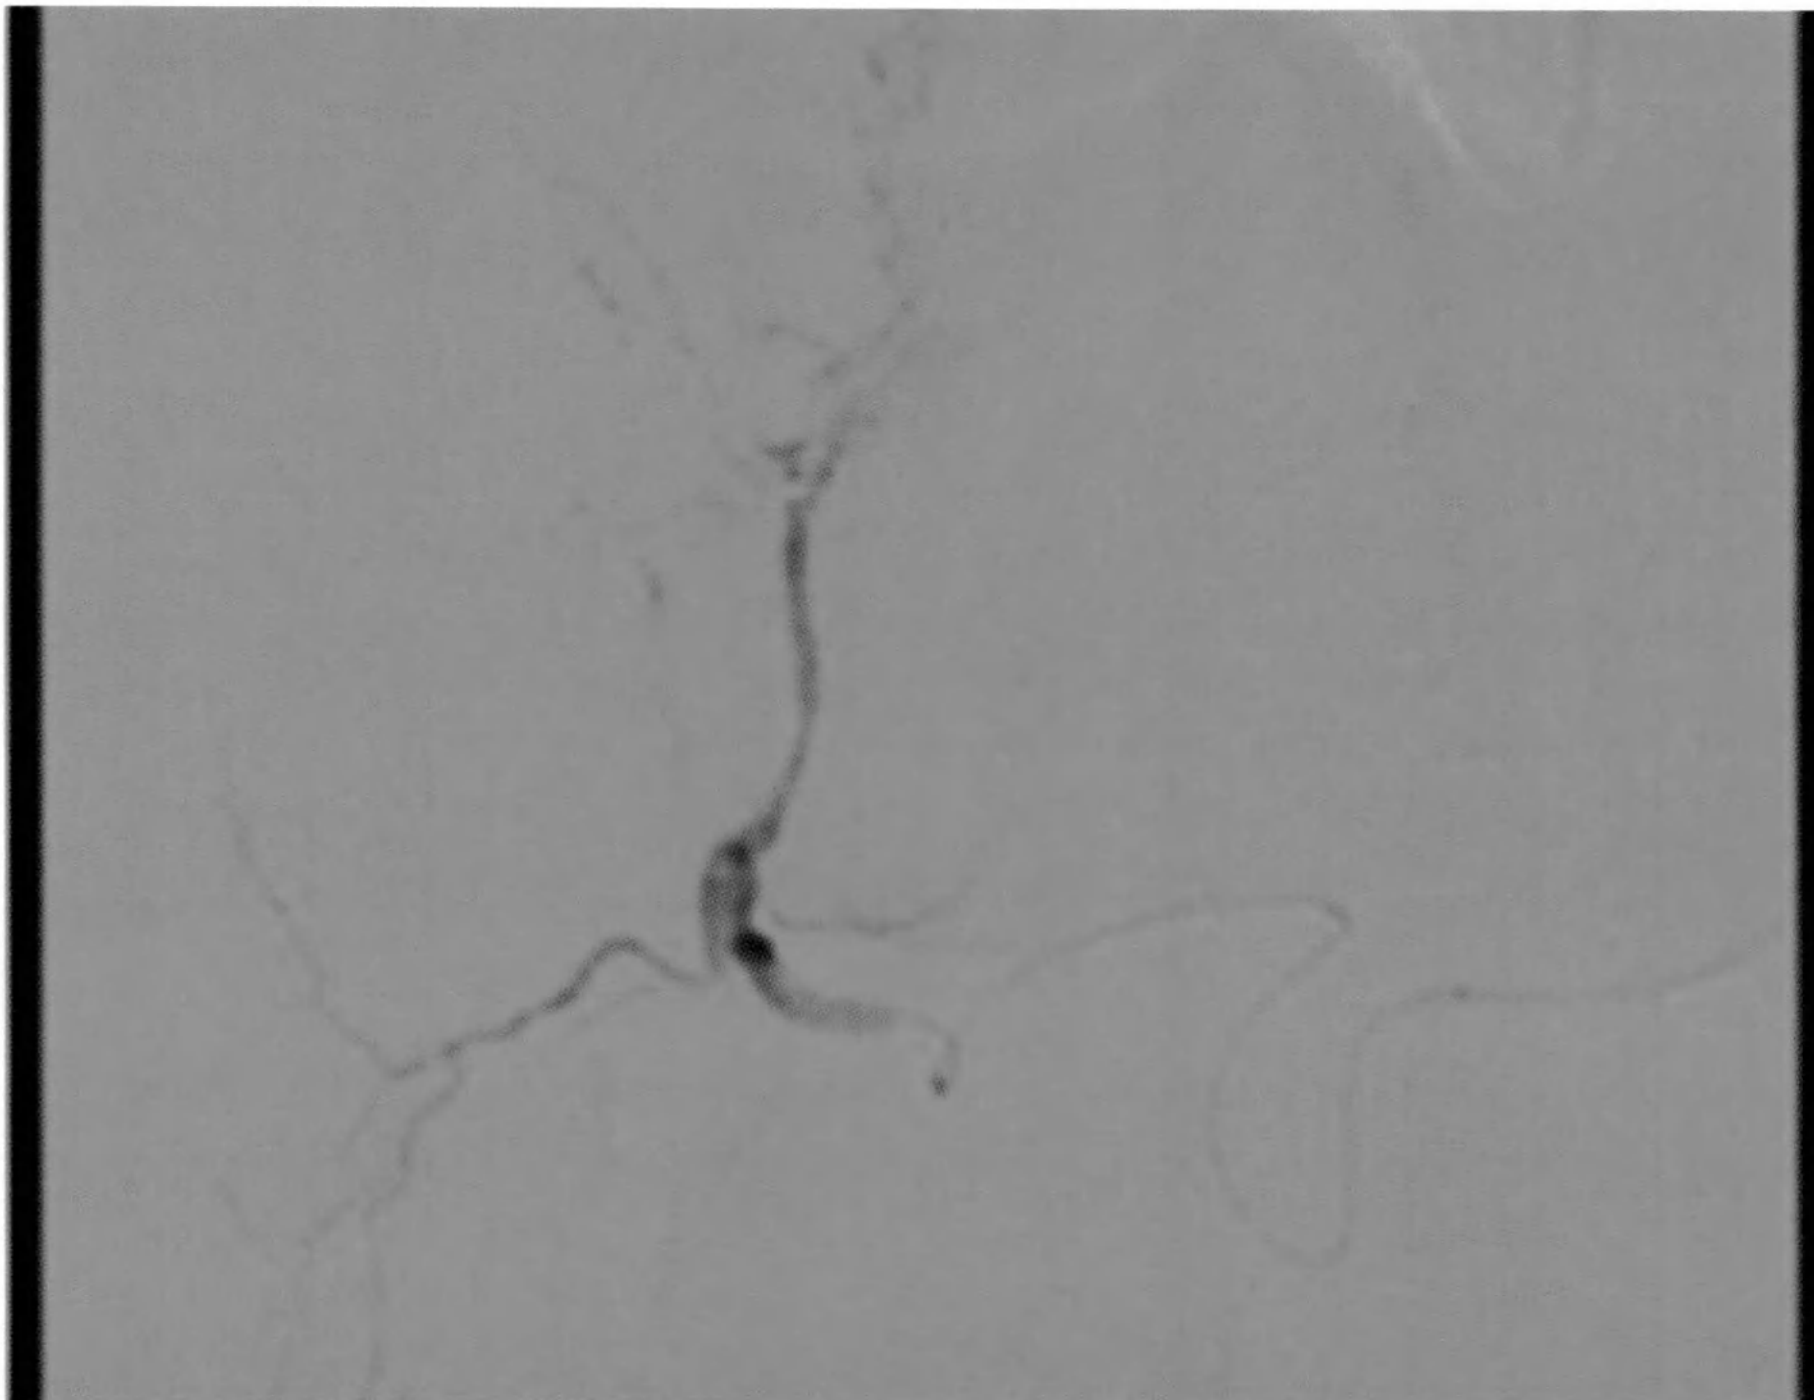


Рисунок 58. Программный модуль двухмерной навигации

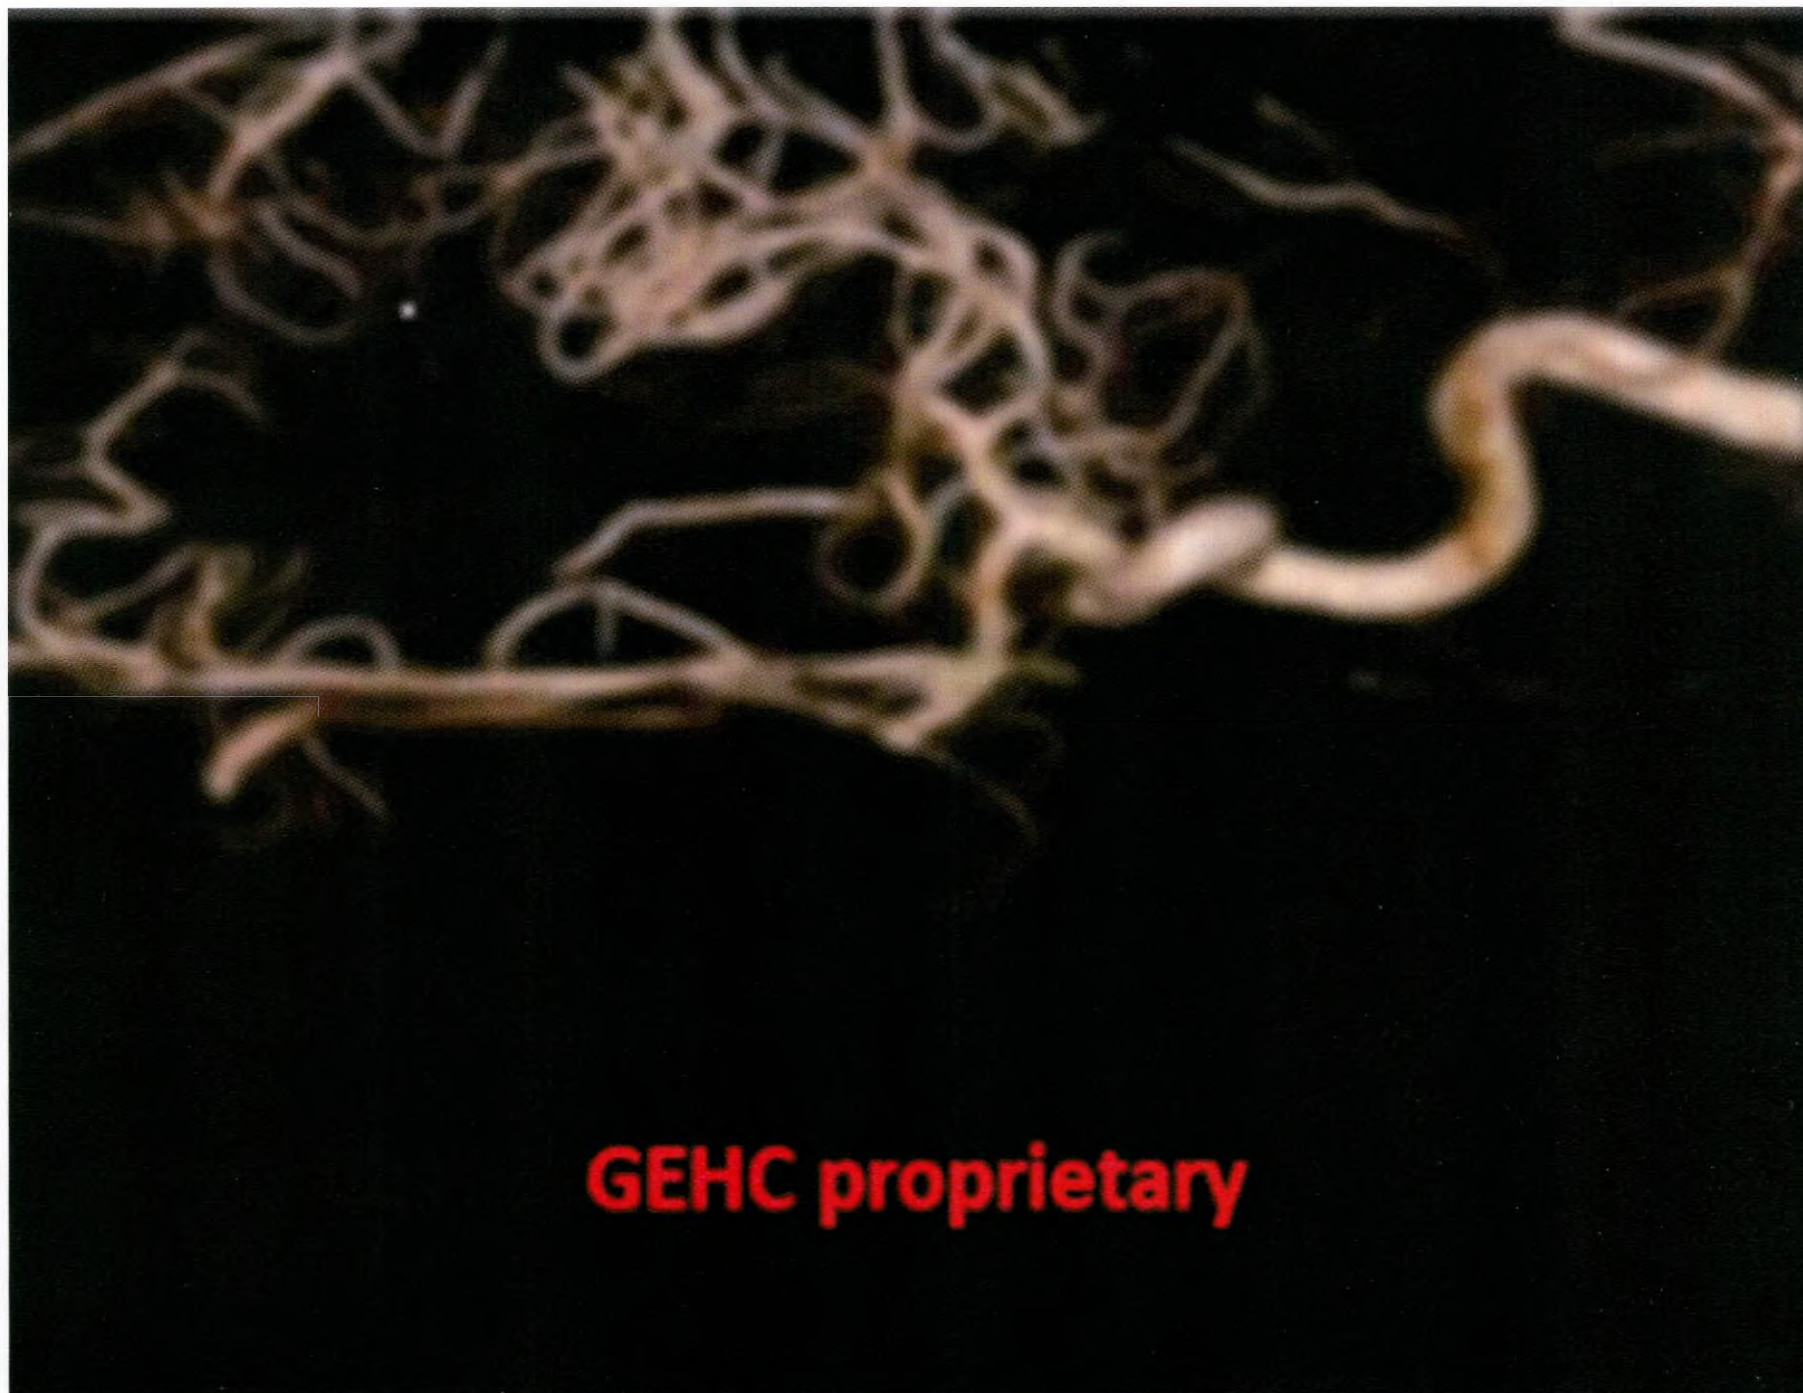


Рисунок 59. Программный модуль получения трехмерных субтрагированных изображений



Рисунок 60. Программный модуль получения трехмерного изображения

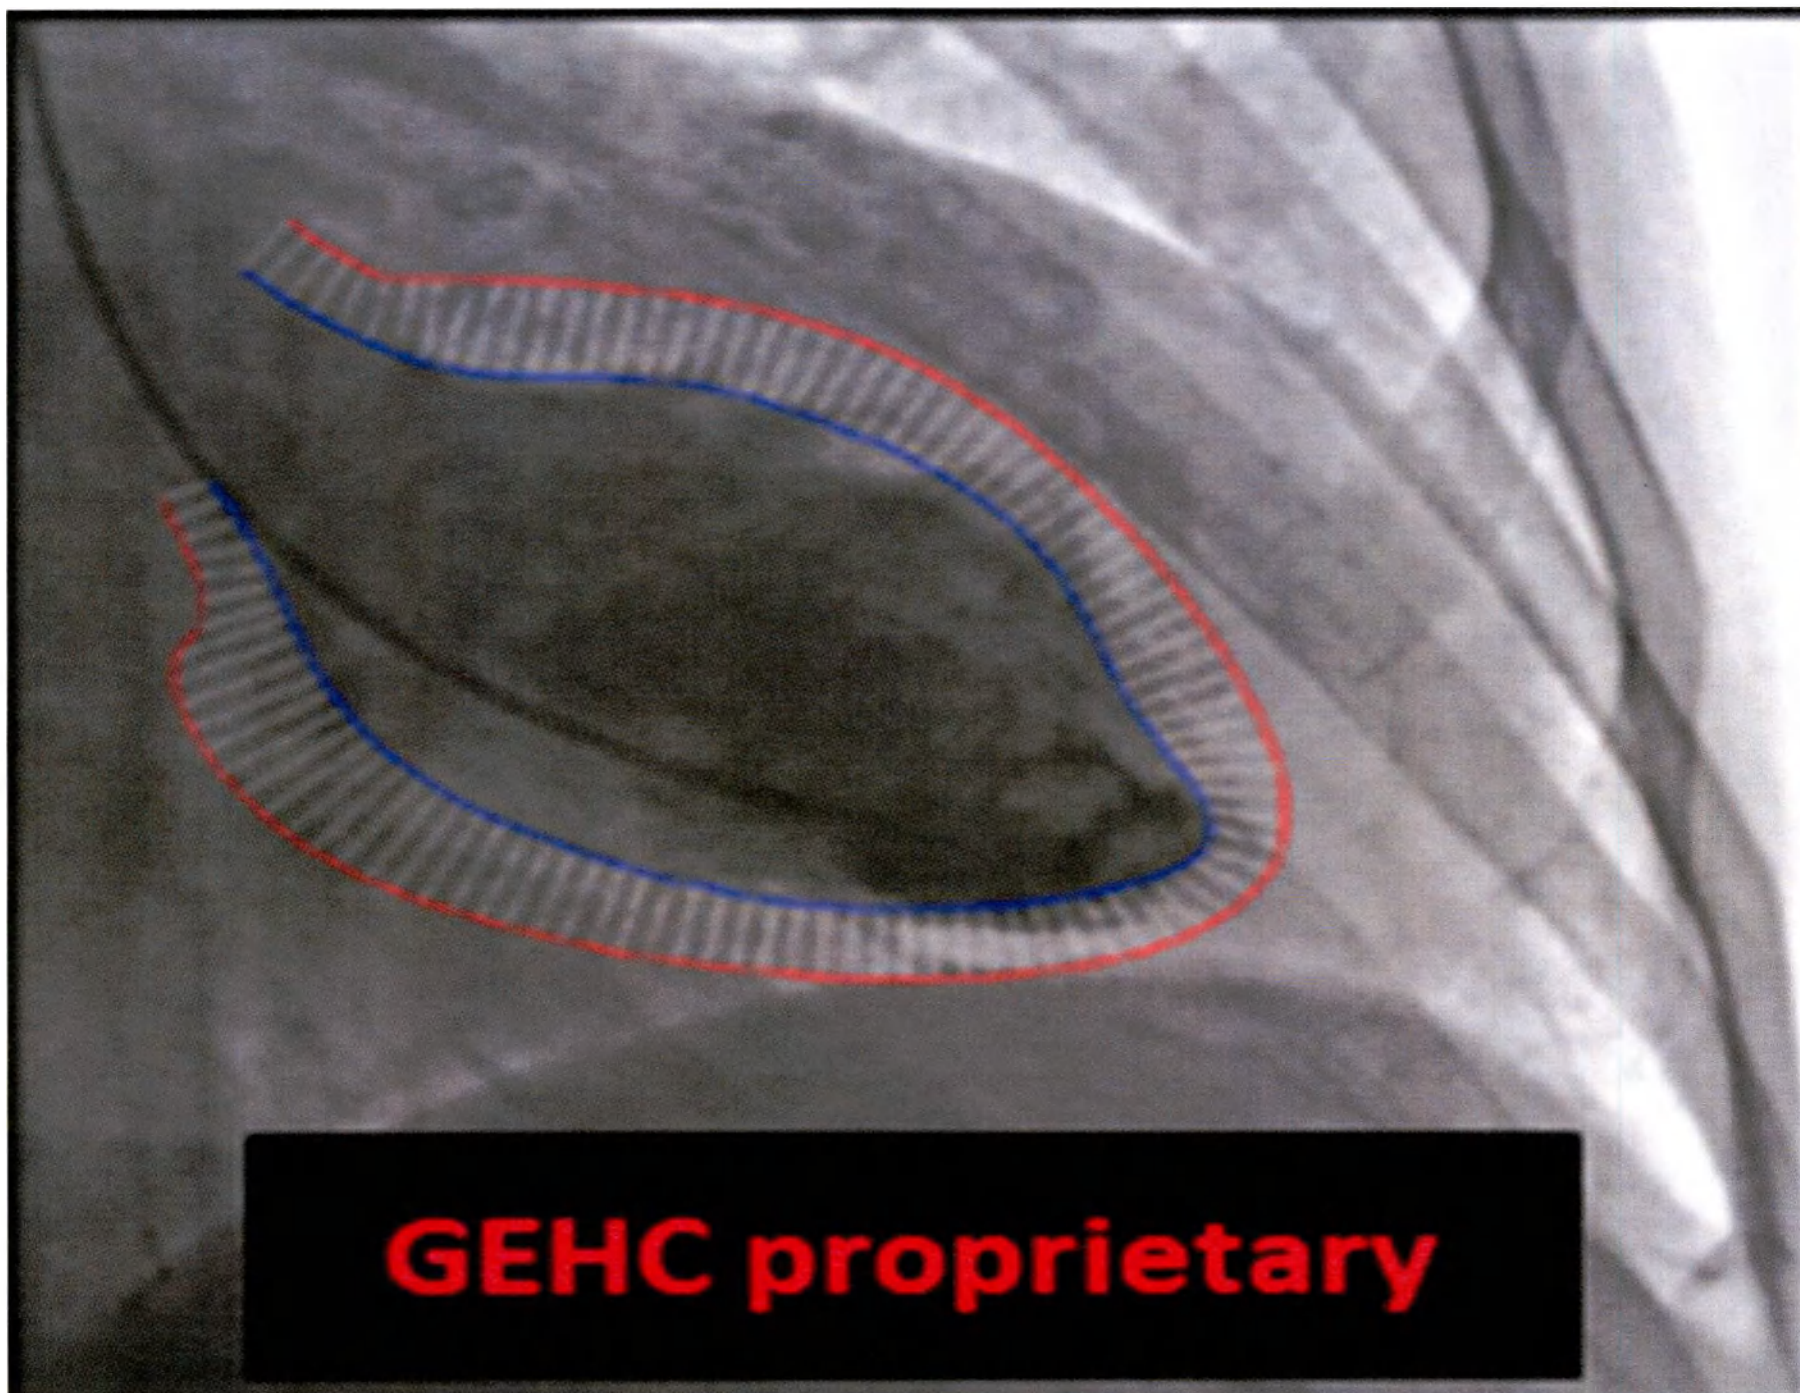


Рисунок 61. Программный модуль кардиологического анализа, включающий анализ стеноза и анализ левого желудочка

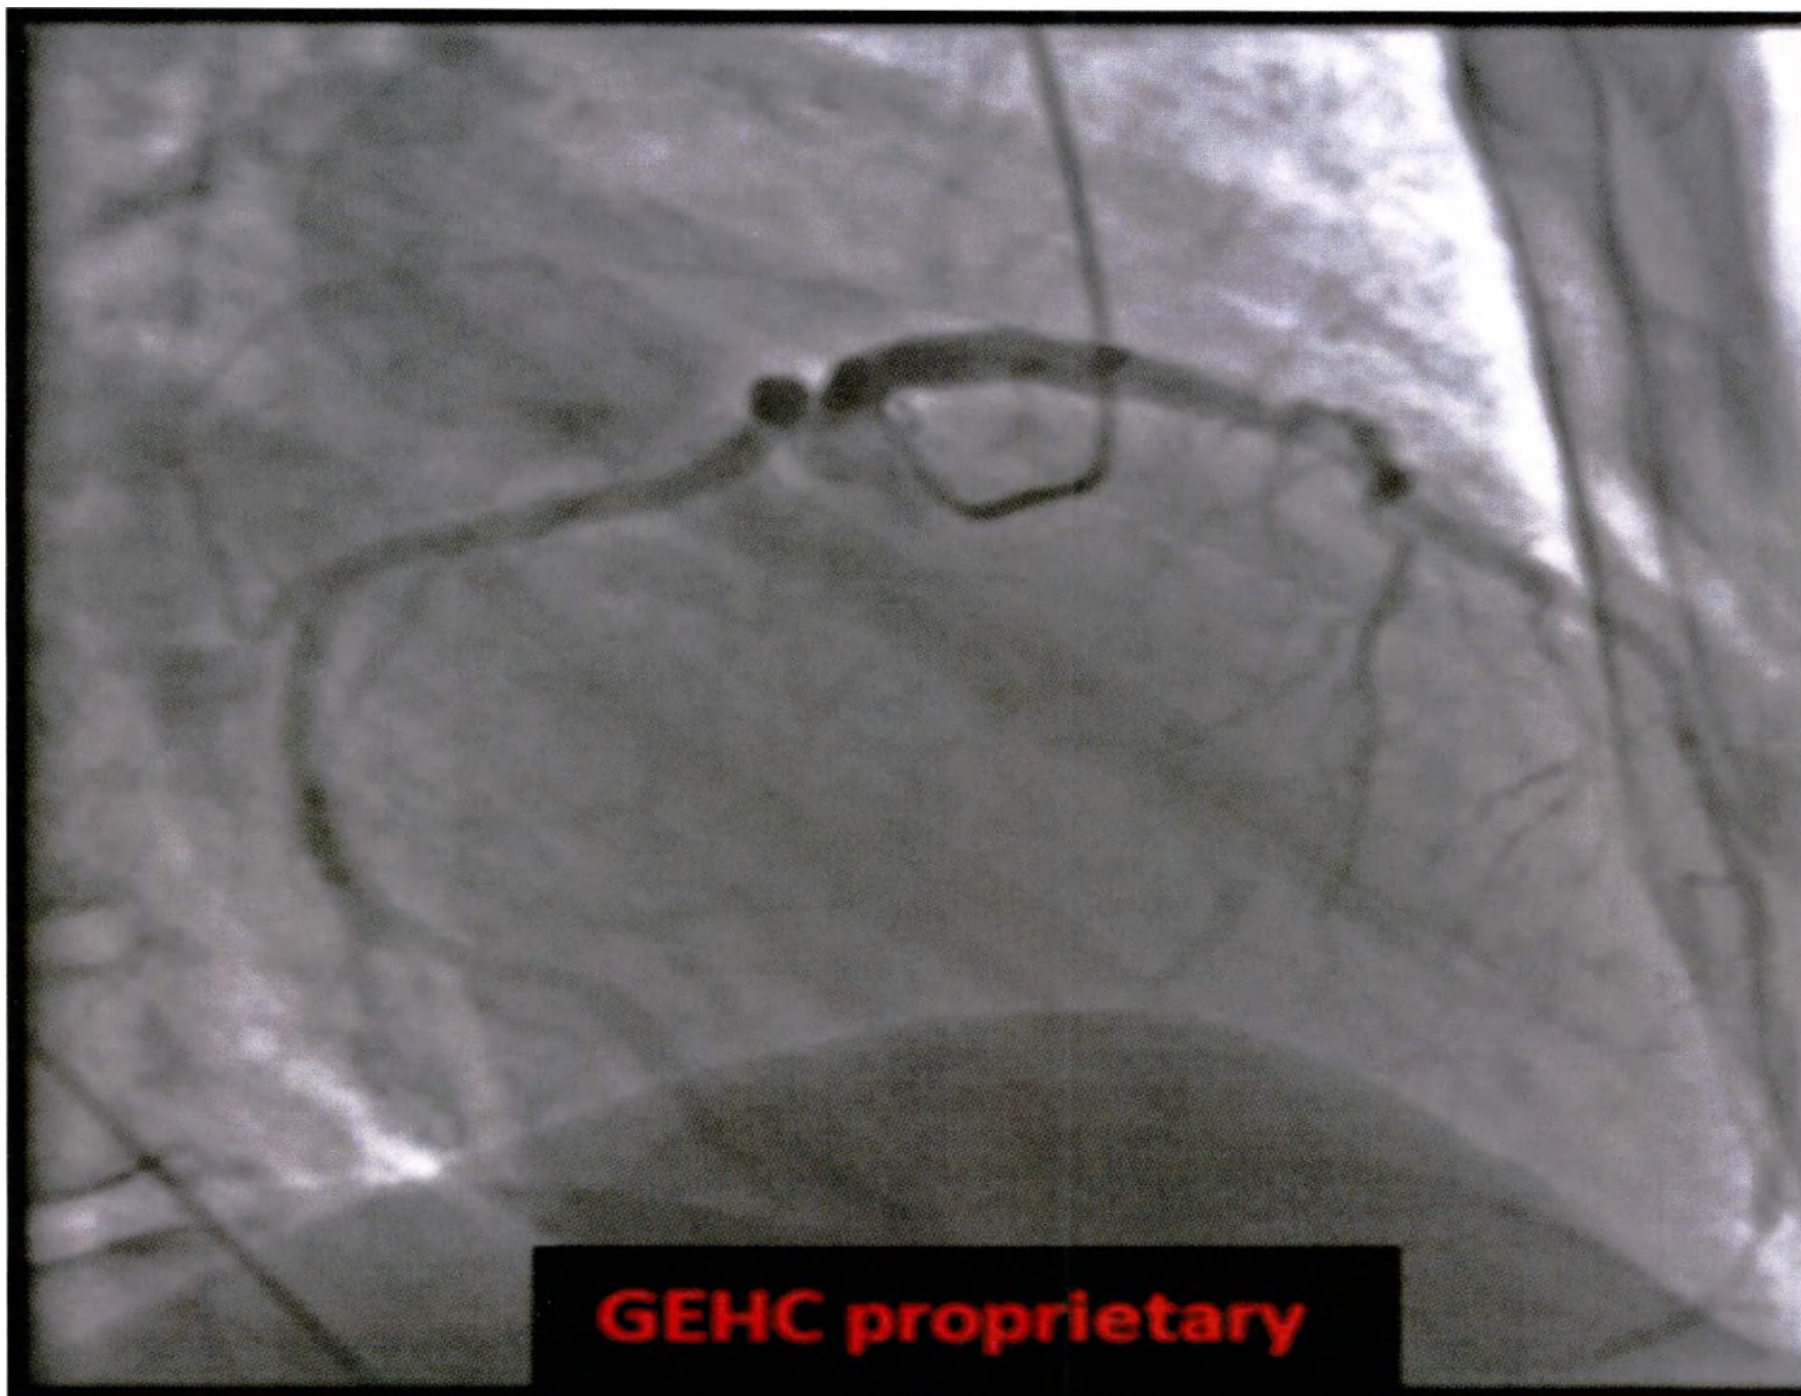


Рисунок 62. Программный модуль для ротационной ангиографии

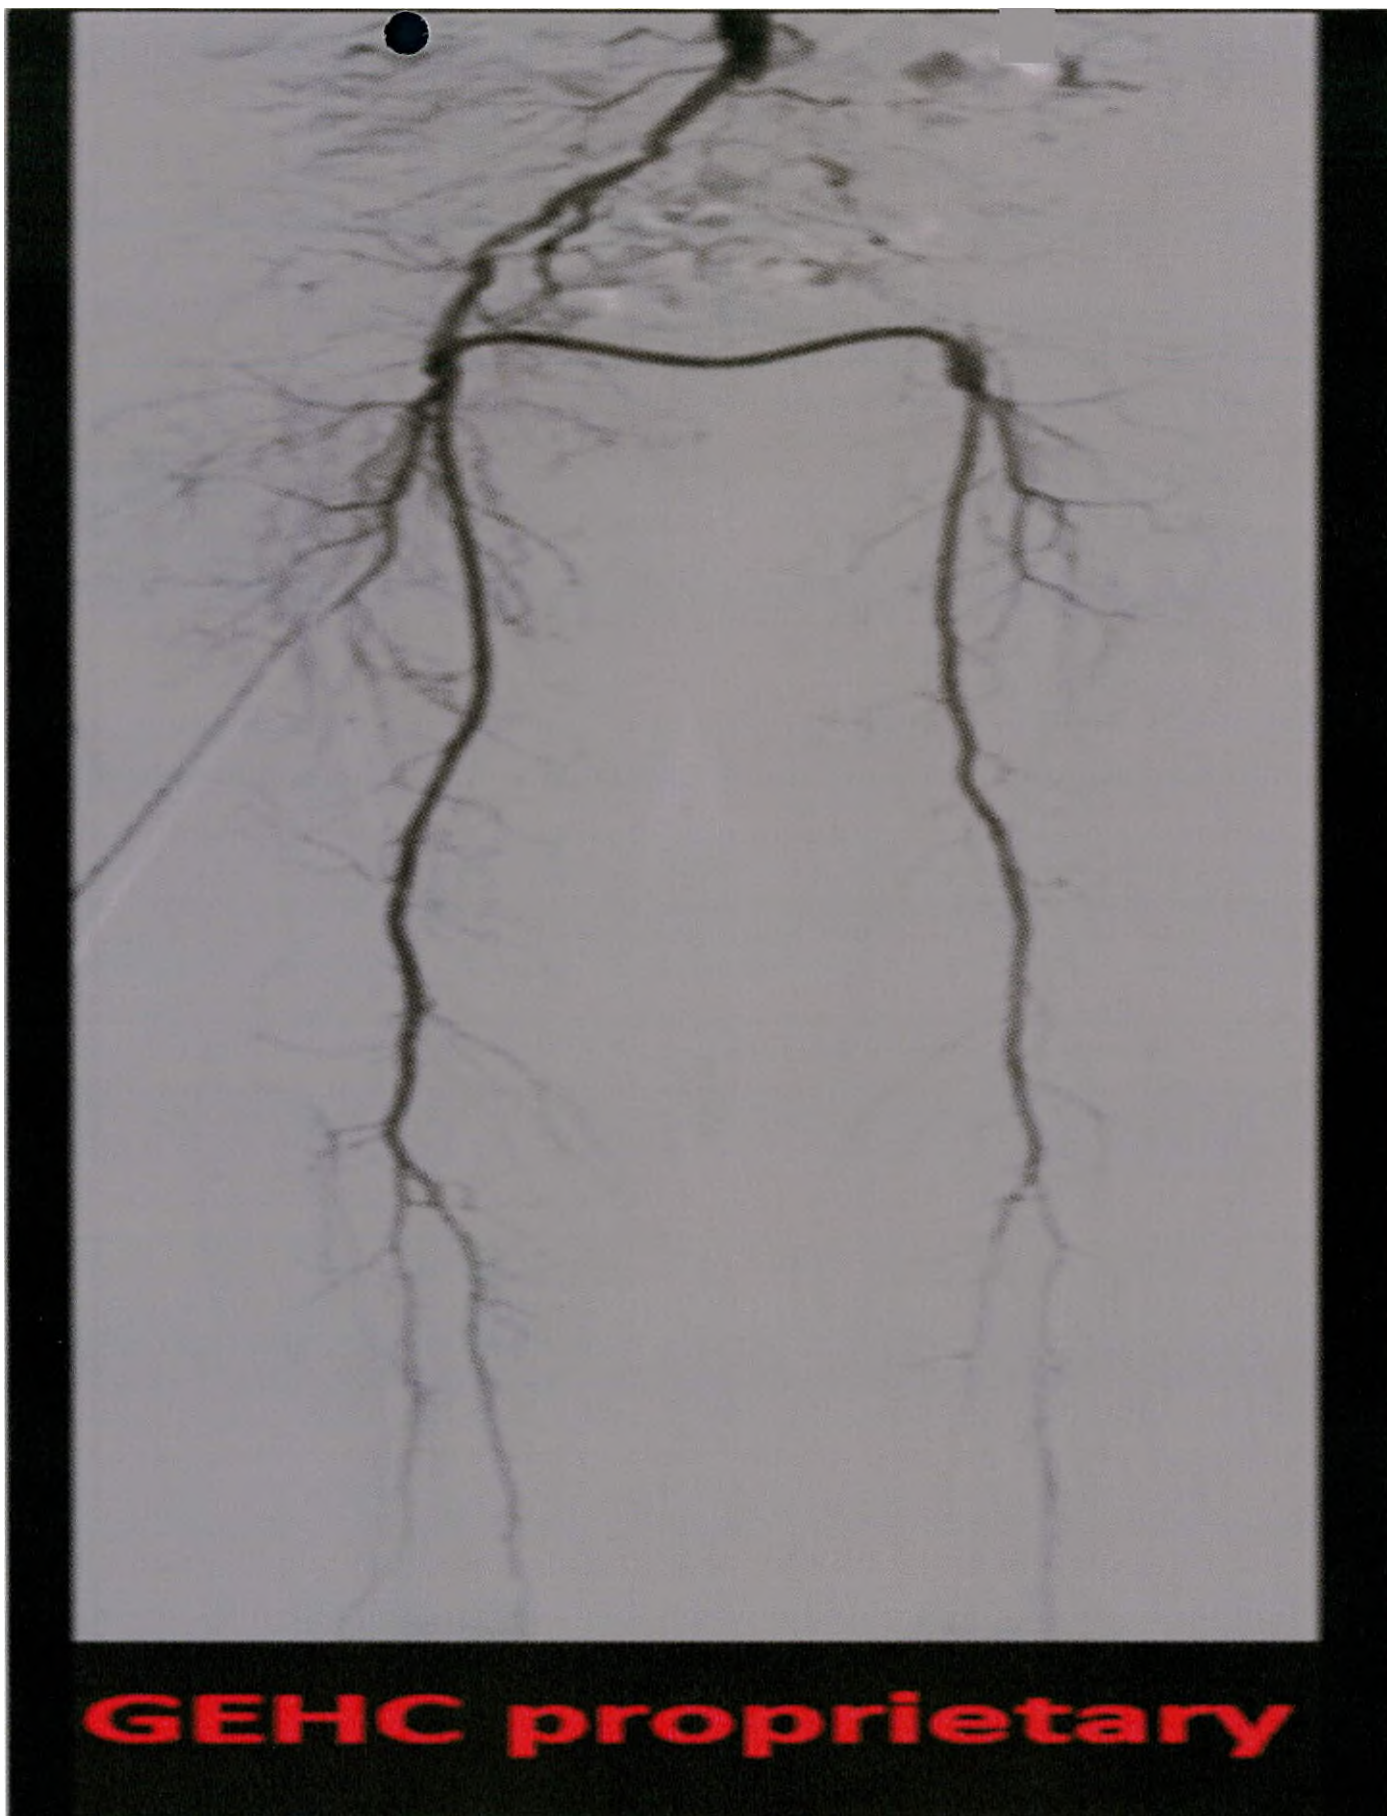


Рисунок 63. Программный модуль для отслеживания болюса контрастного вещества на всем протяжении сосуда с субтракцией



Рисунок 64. Программный модуль получения трехмерных изображений с улучшенной визуализацией мягких и костных тканей



Рисунок 65. Фантомы для калибровки

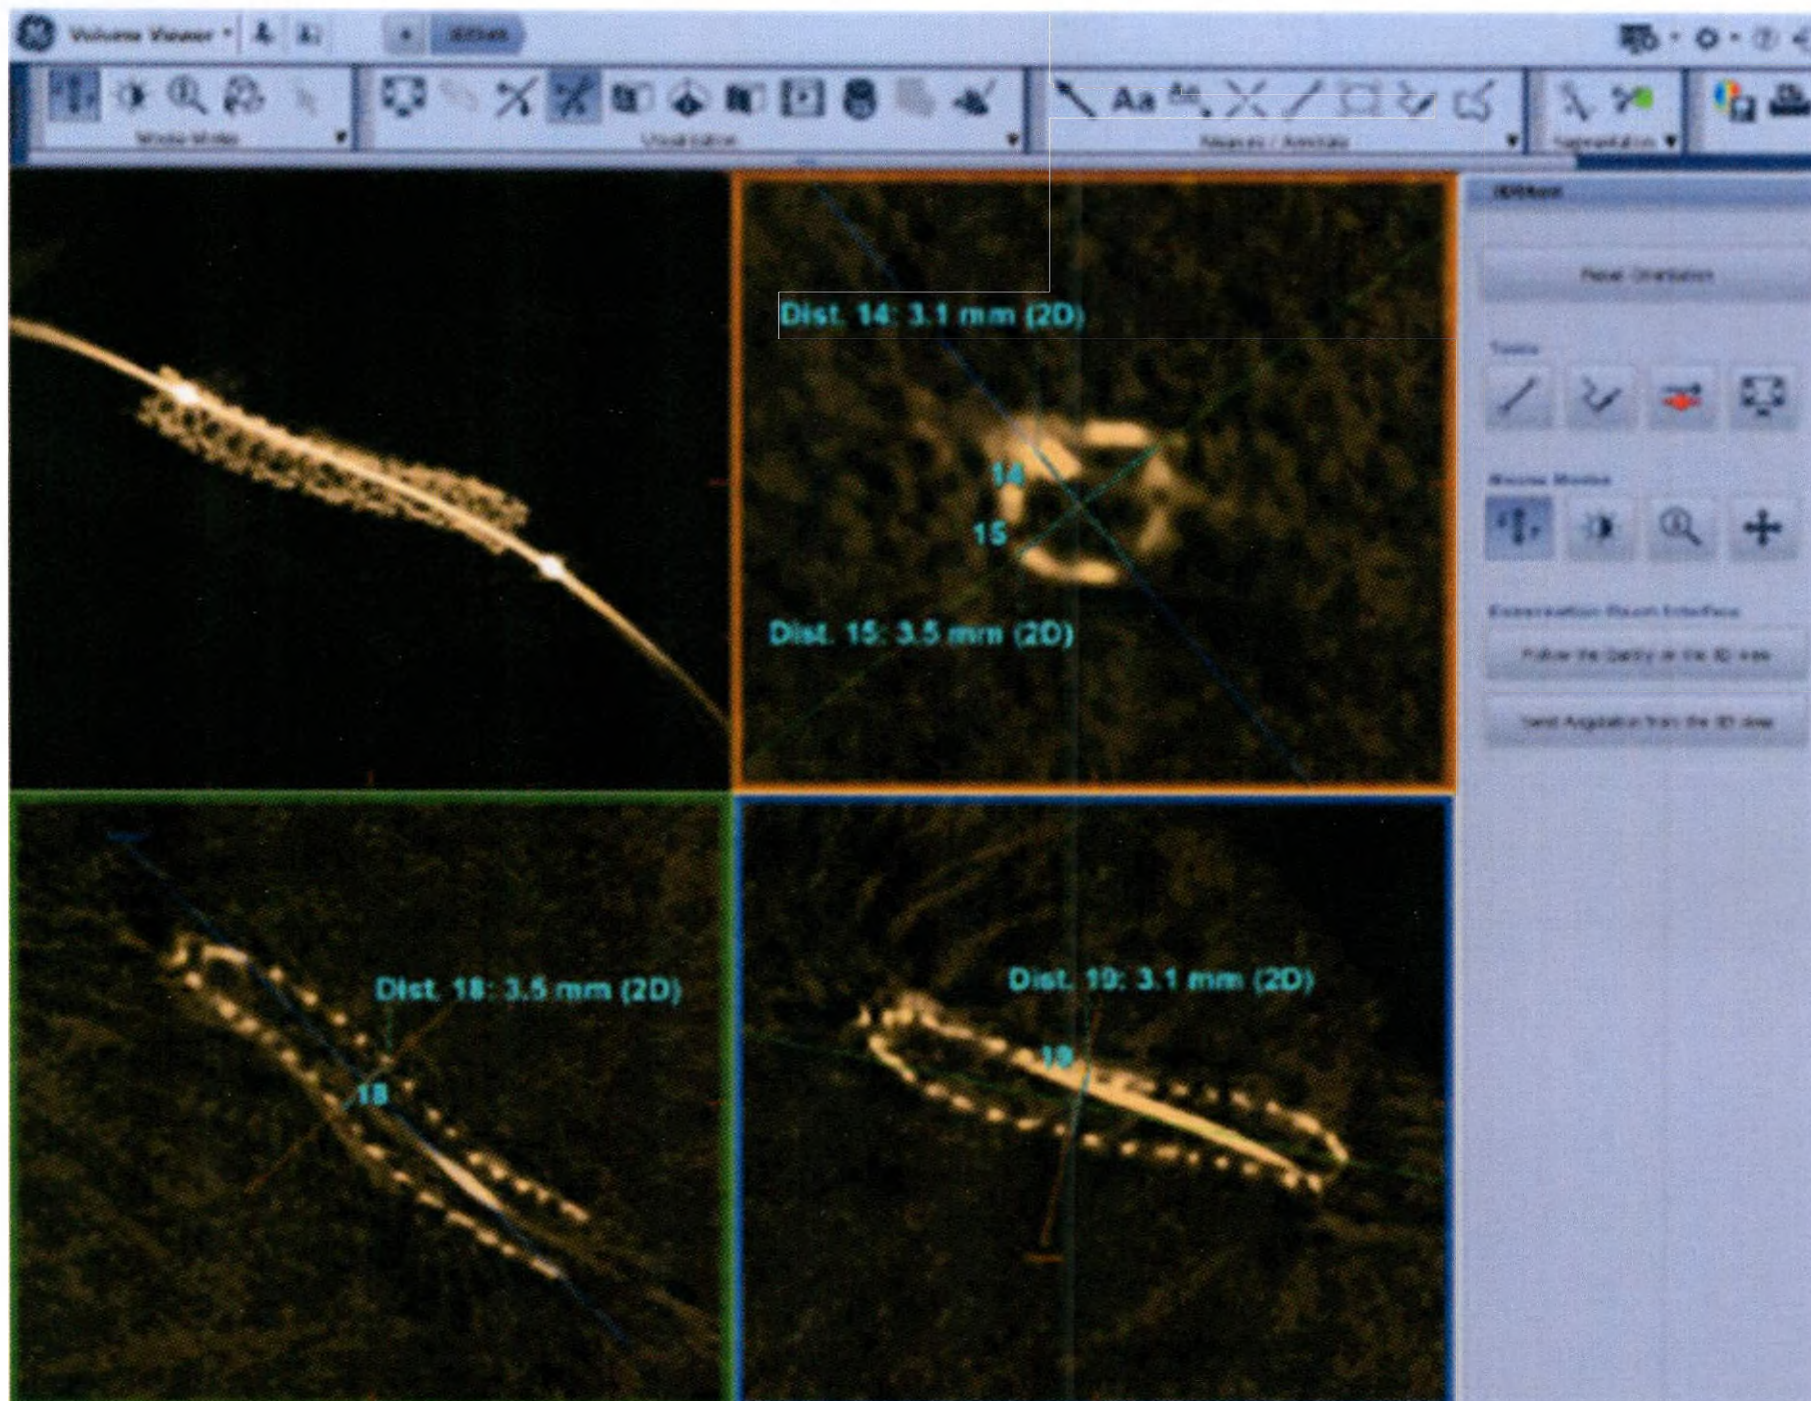


Рисунок 66. Программный пакет трехмерной визуализации коронарного стента с автоматической сегментацией

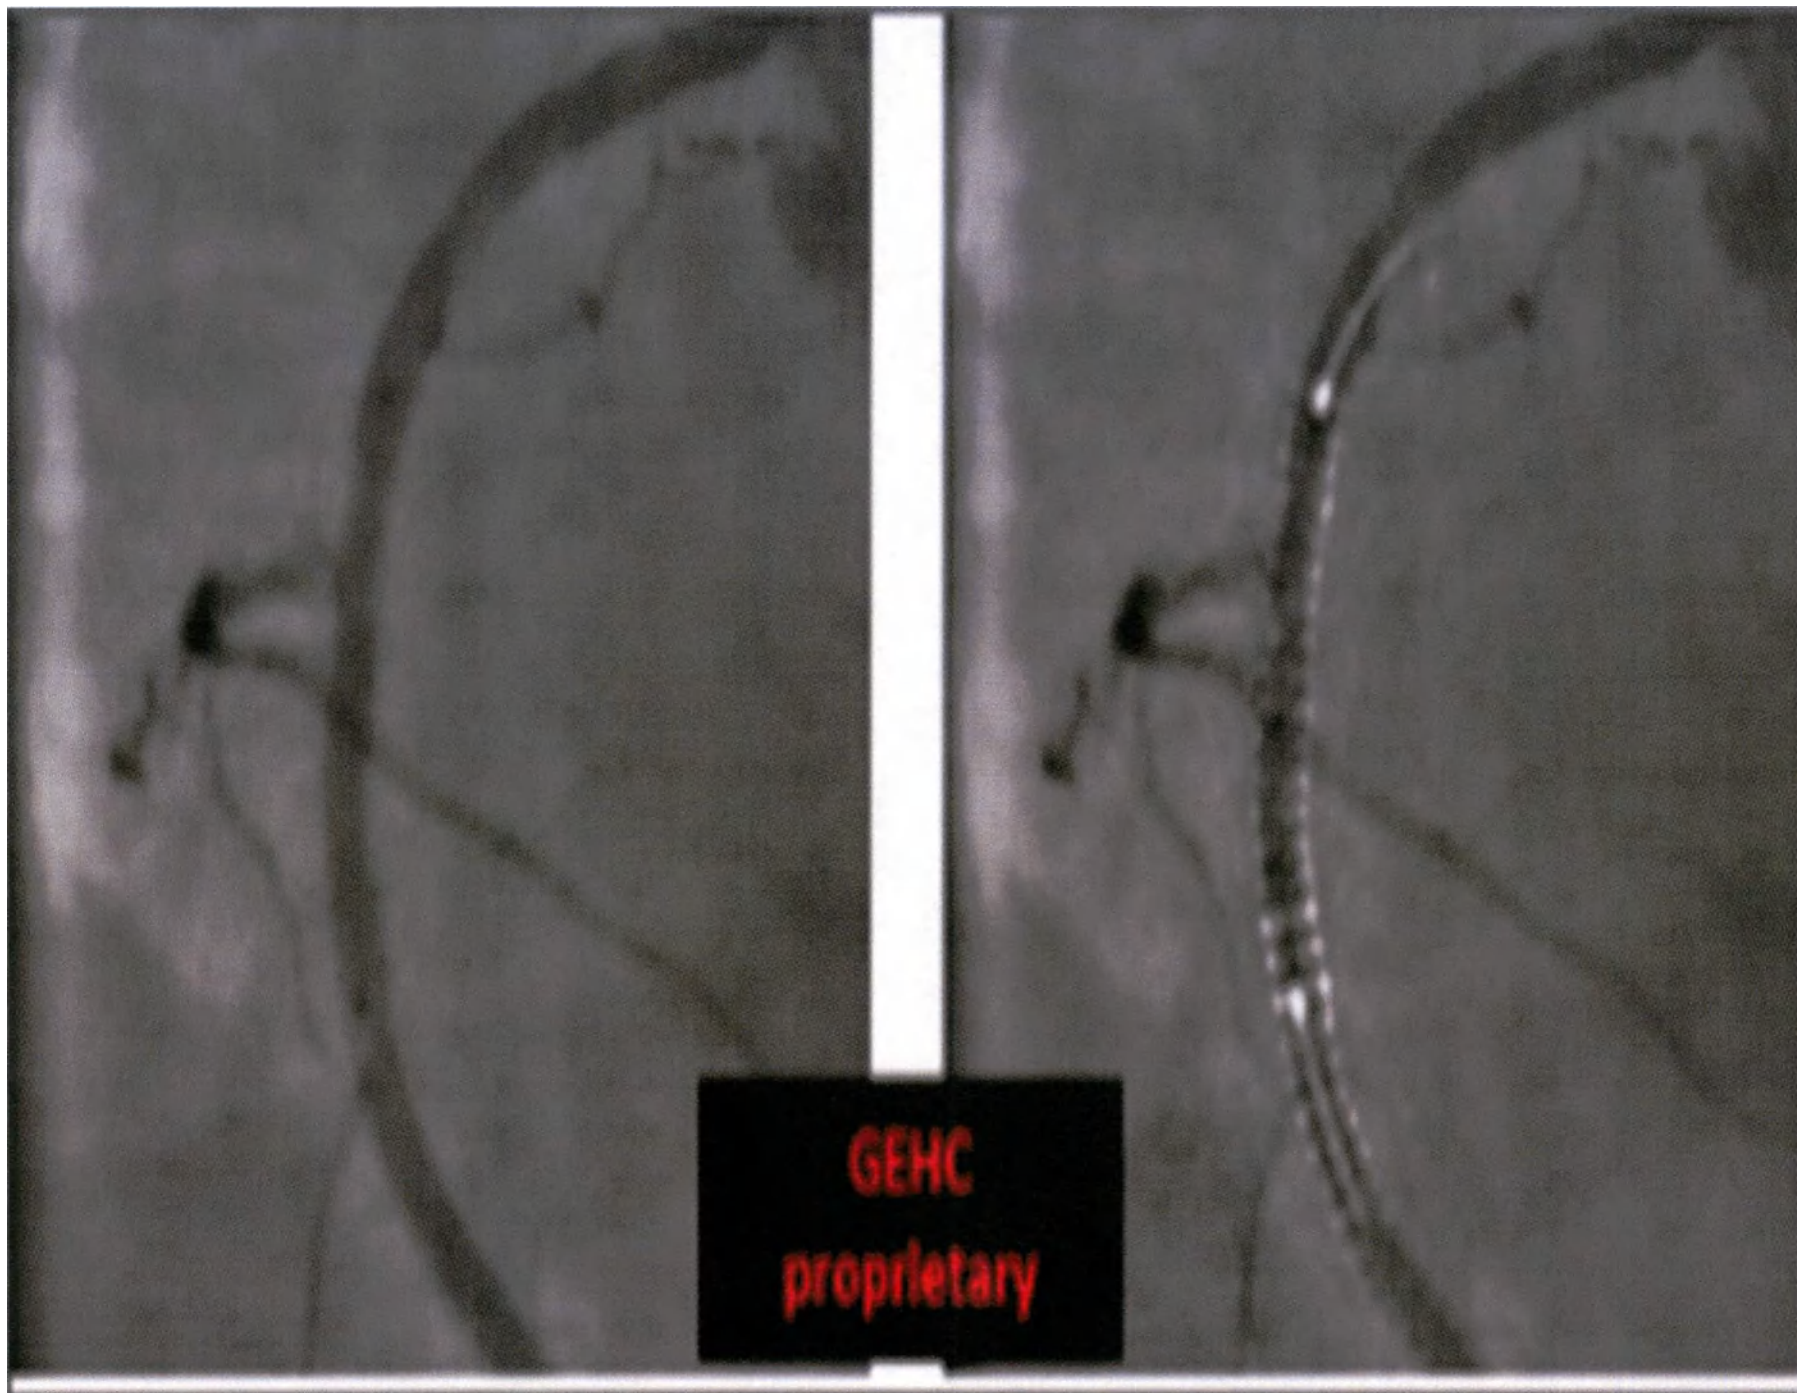


Рисунок 67. Программный модуль улучшенной визуализации стентов и высококонтрастной рентгеноскопии

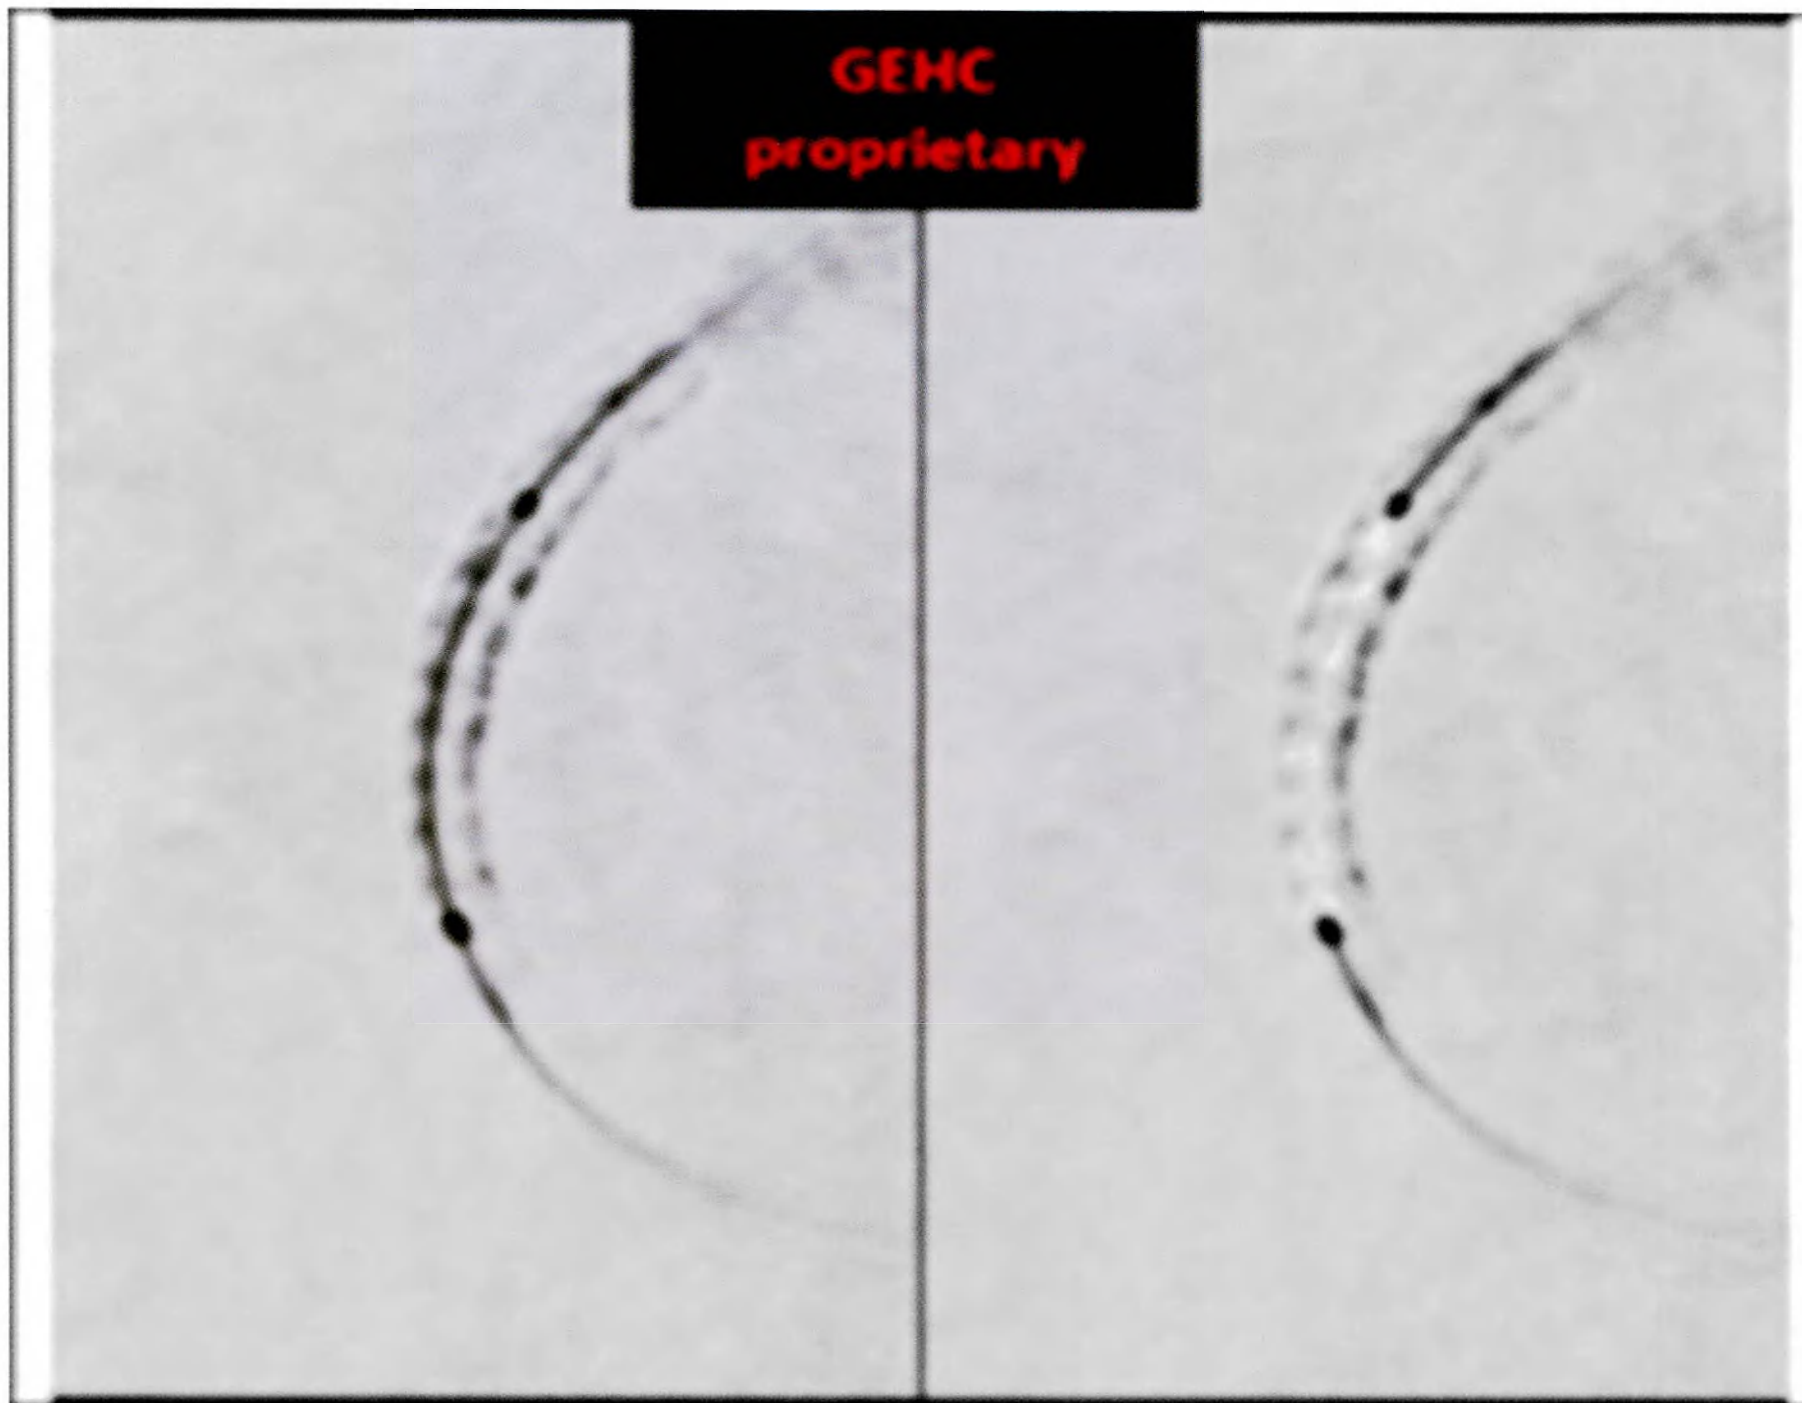


Рисунок 68. Программный модуль улучшенной визуализации стентов коронарных артерий



Рисунок 69. Интерфейс управления трехмерными изображениями от стола в процедурной



Рисунок 70. Подставка под интерфейс управления трехмерными изображениями от стола в процедурной

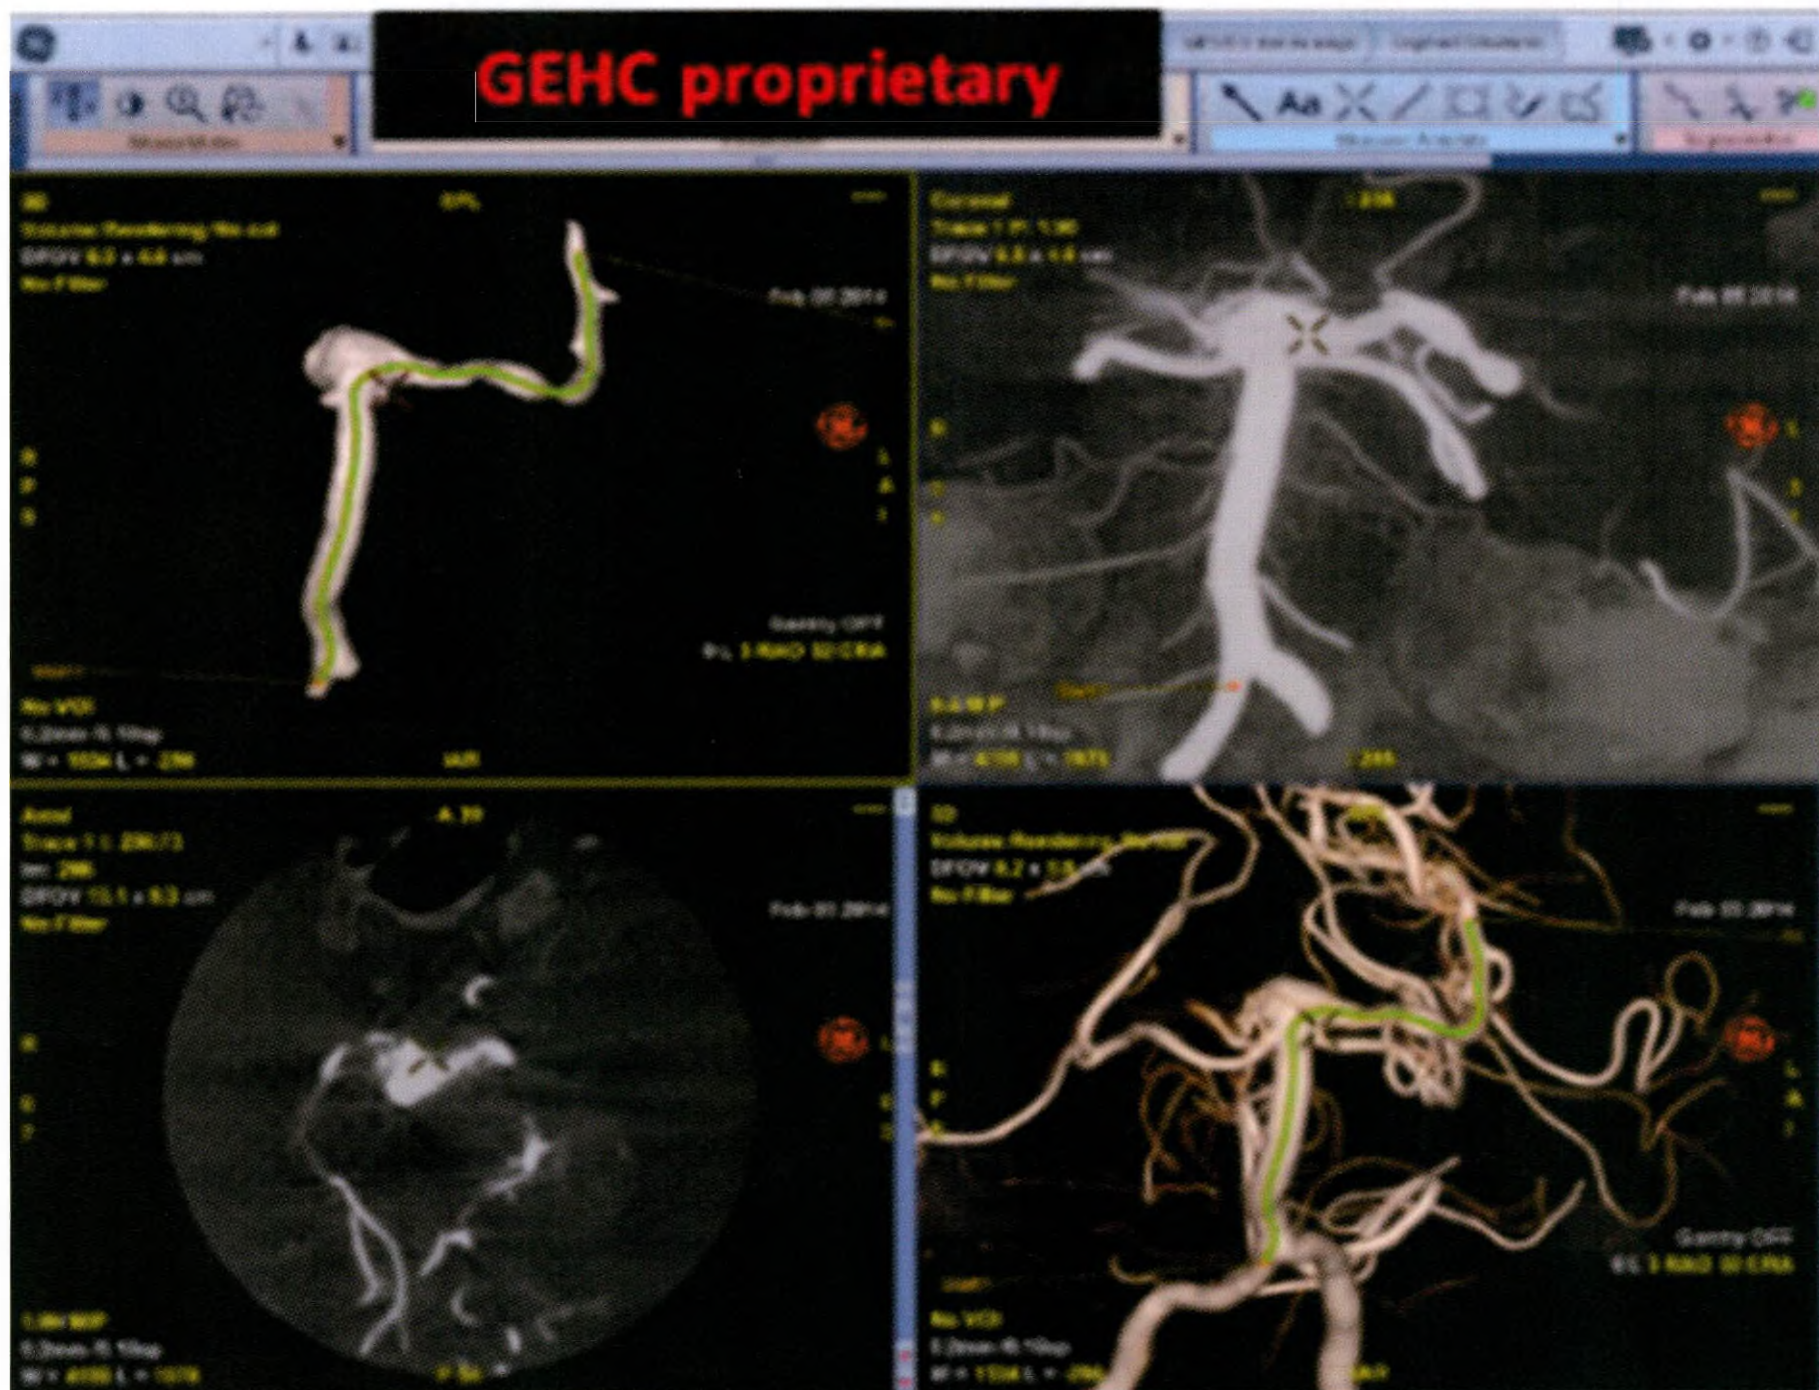


Рисунок 71. Программные модули для экспертного анализа и получения медицинских изображений



Рисунок 72. Программный модуль количественного кардиологического анализа

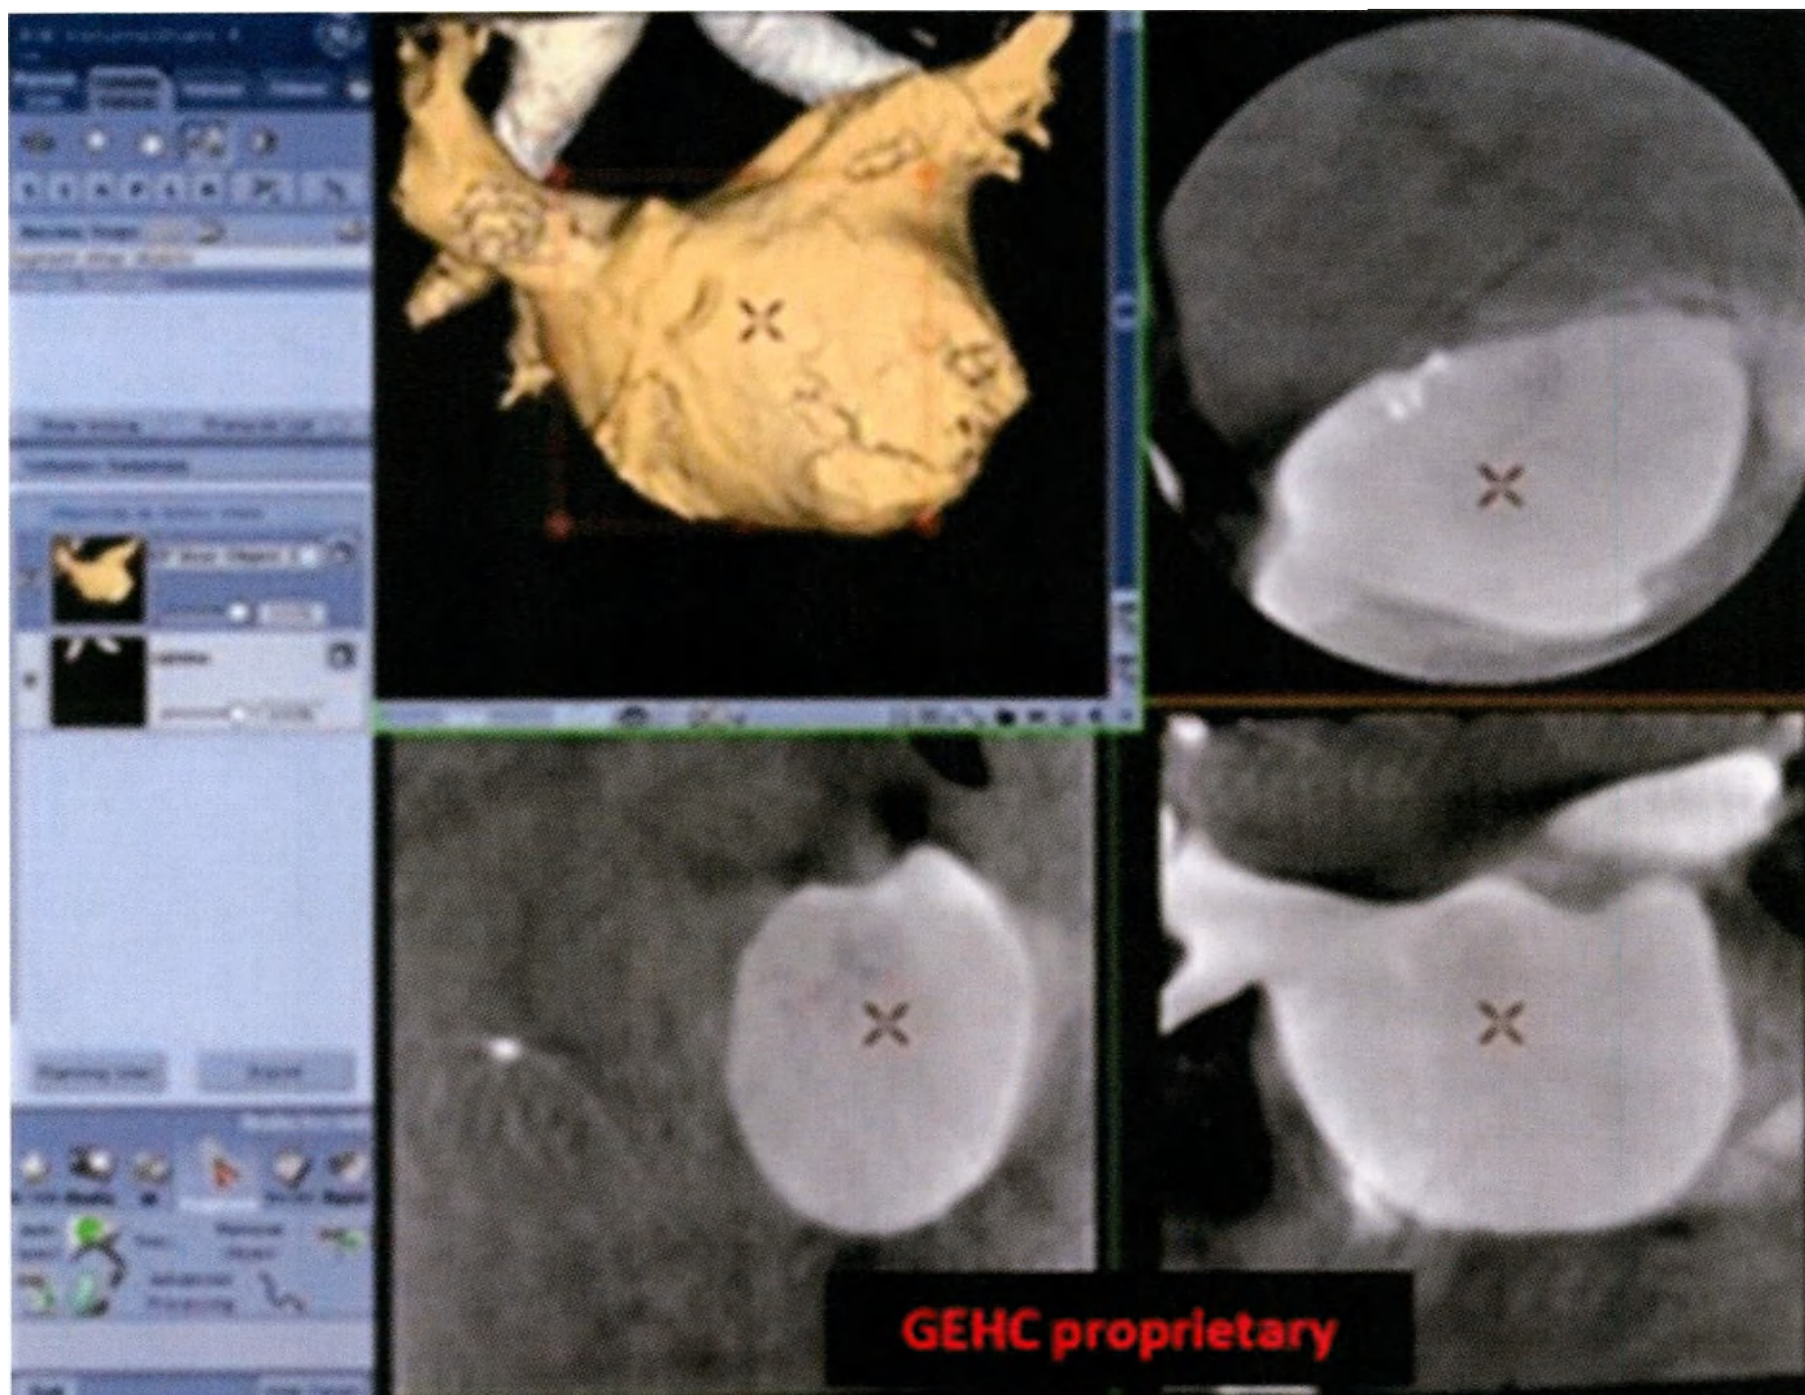


Рисунок 73. Программный модуль анализа клапанов сердца и трехмерной навигации

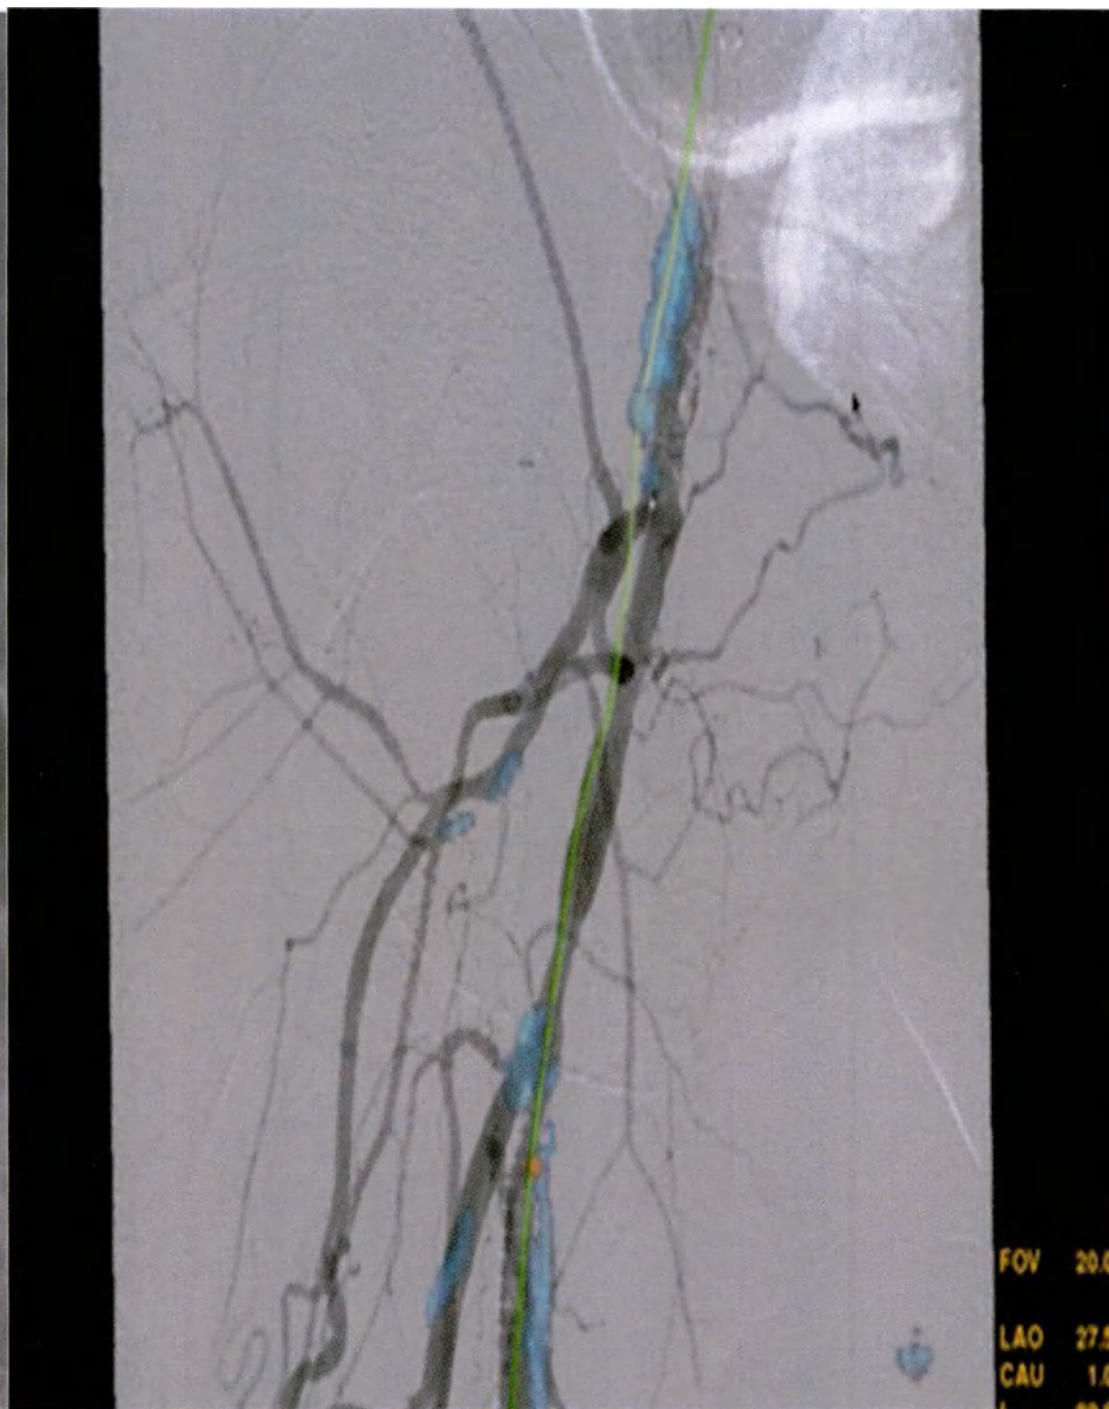


Рисунок 74. Программный модуль внутрисосудистой трехмерной навигации

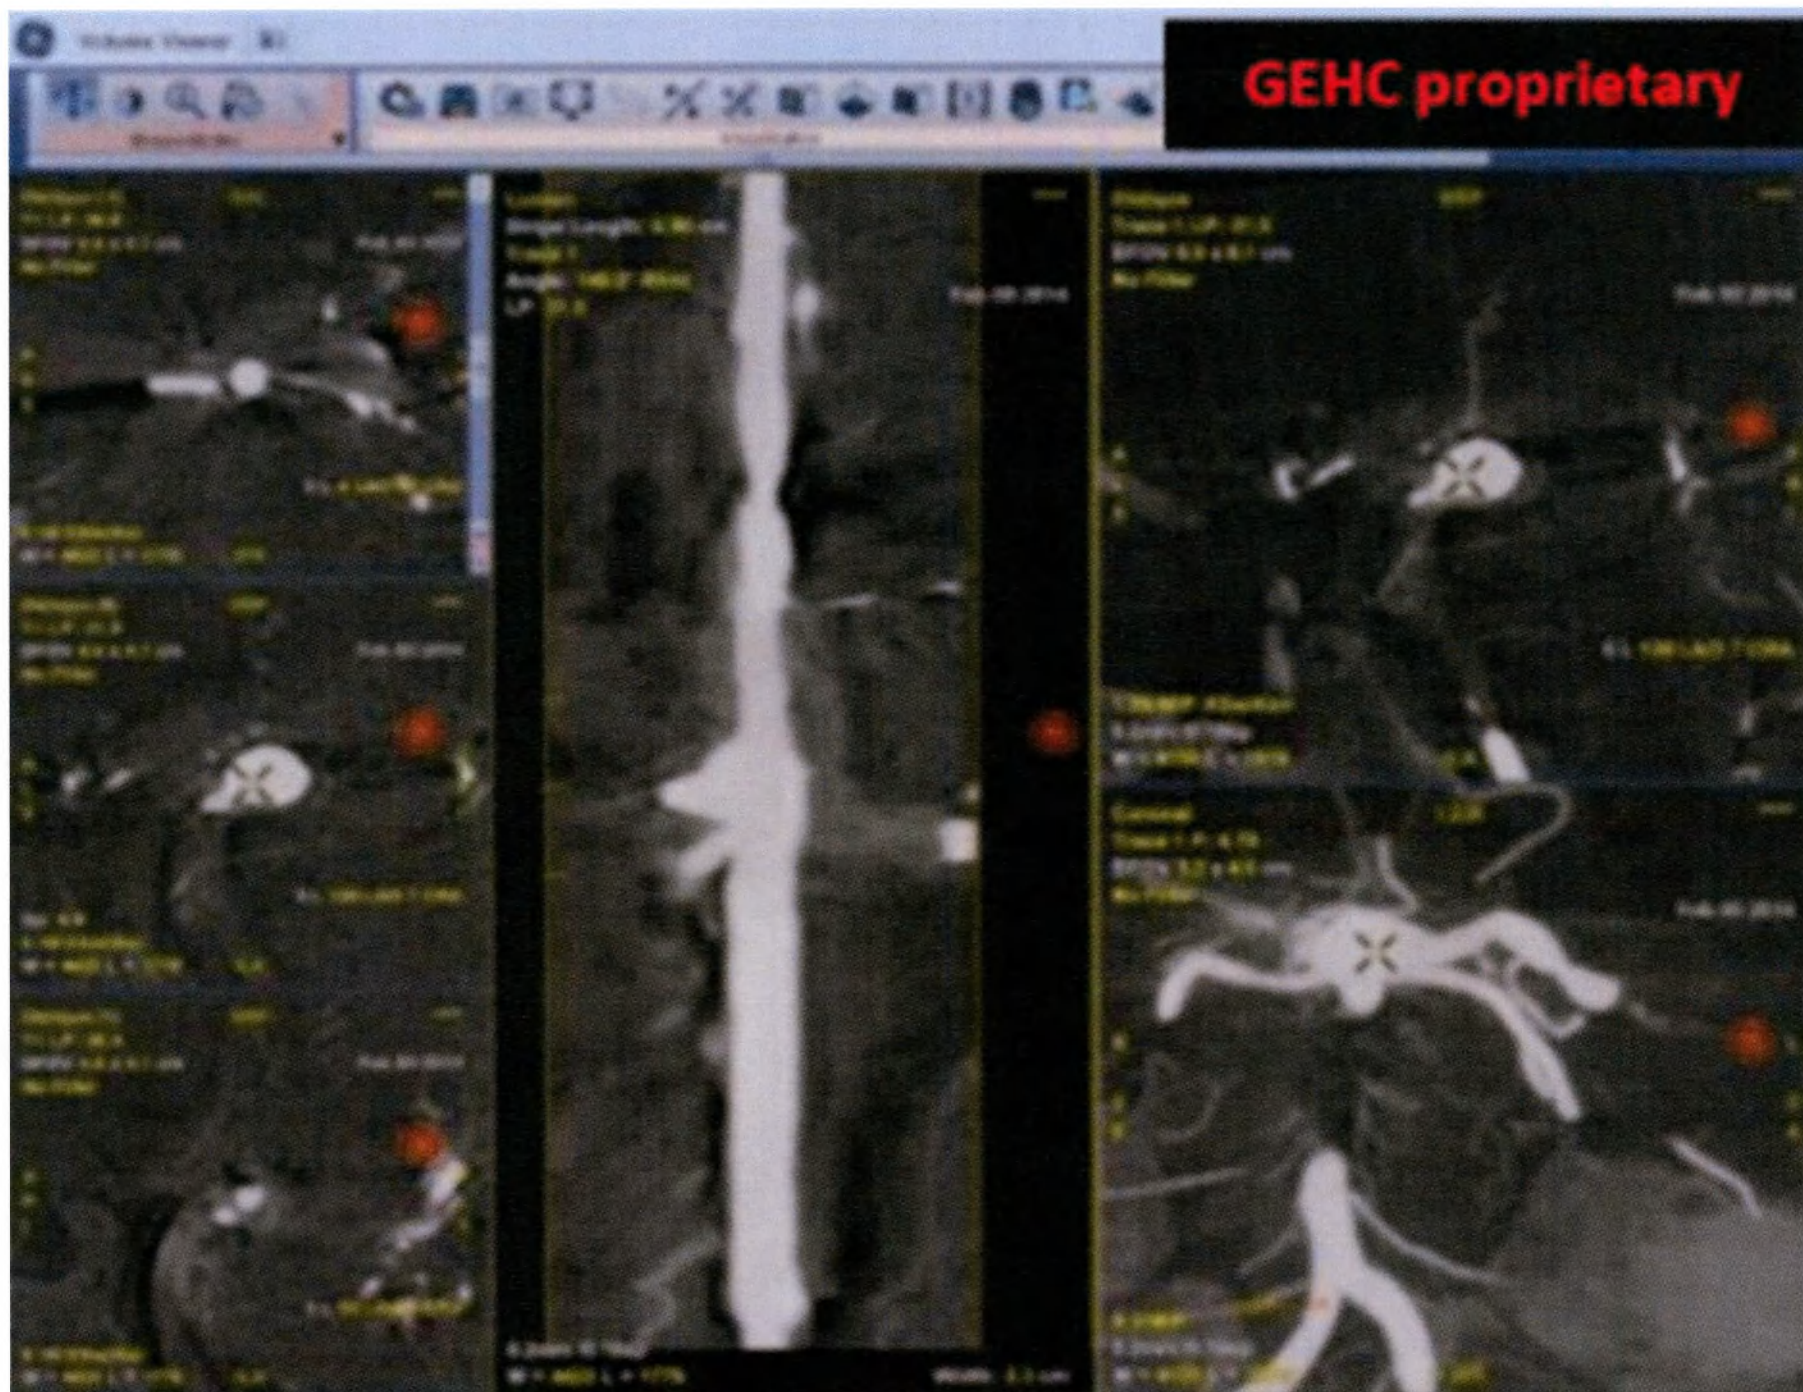


Рисунок 75. Программный модуль внутрисосудистой трехмерной навигации аорты



Рисунок 76. Программные модули функциональной трехмерной навигации

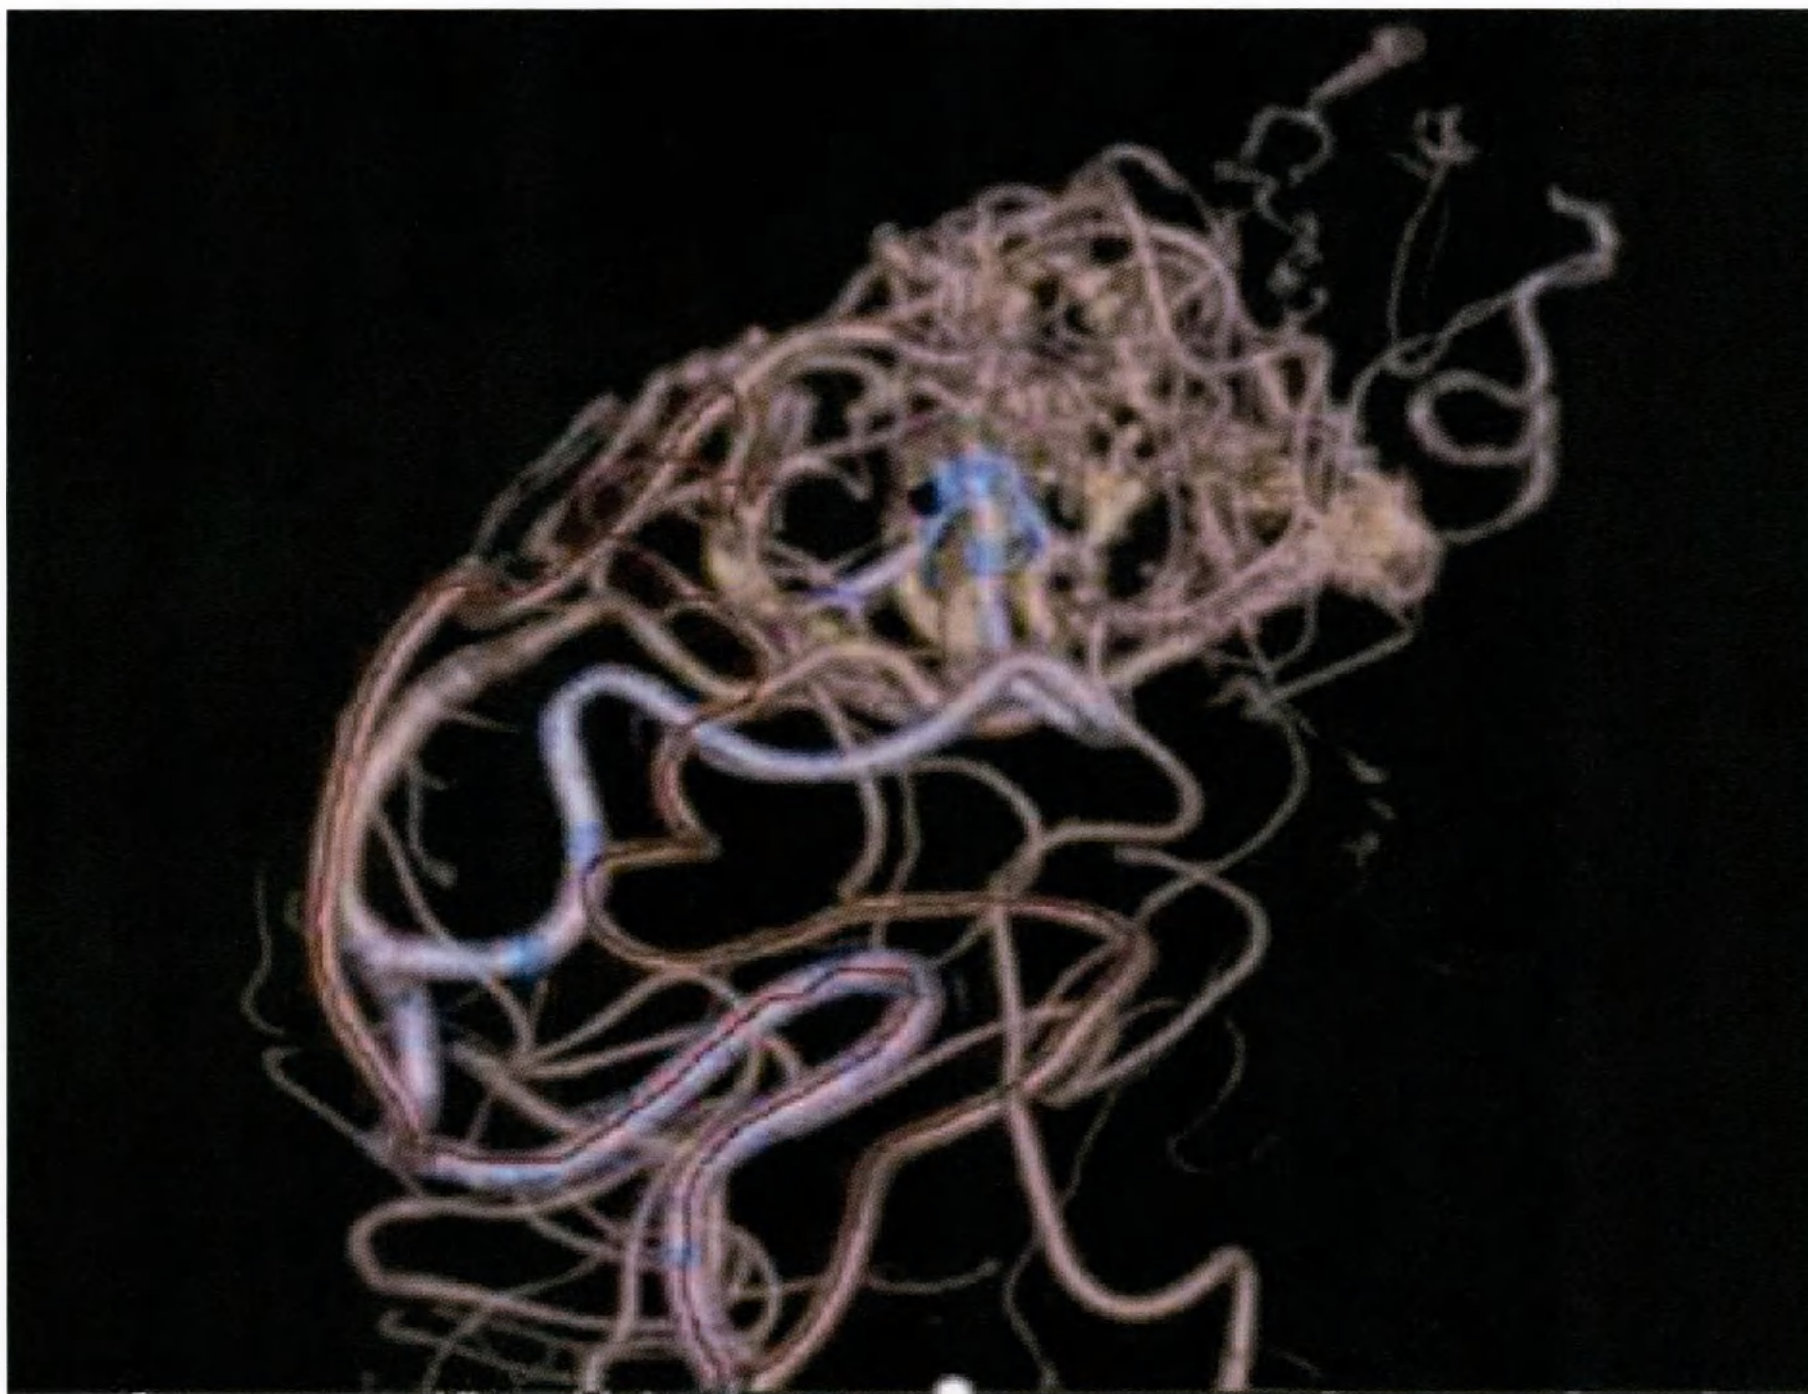


Рисунок 77. Программный модуль для эмболизаций

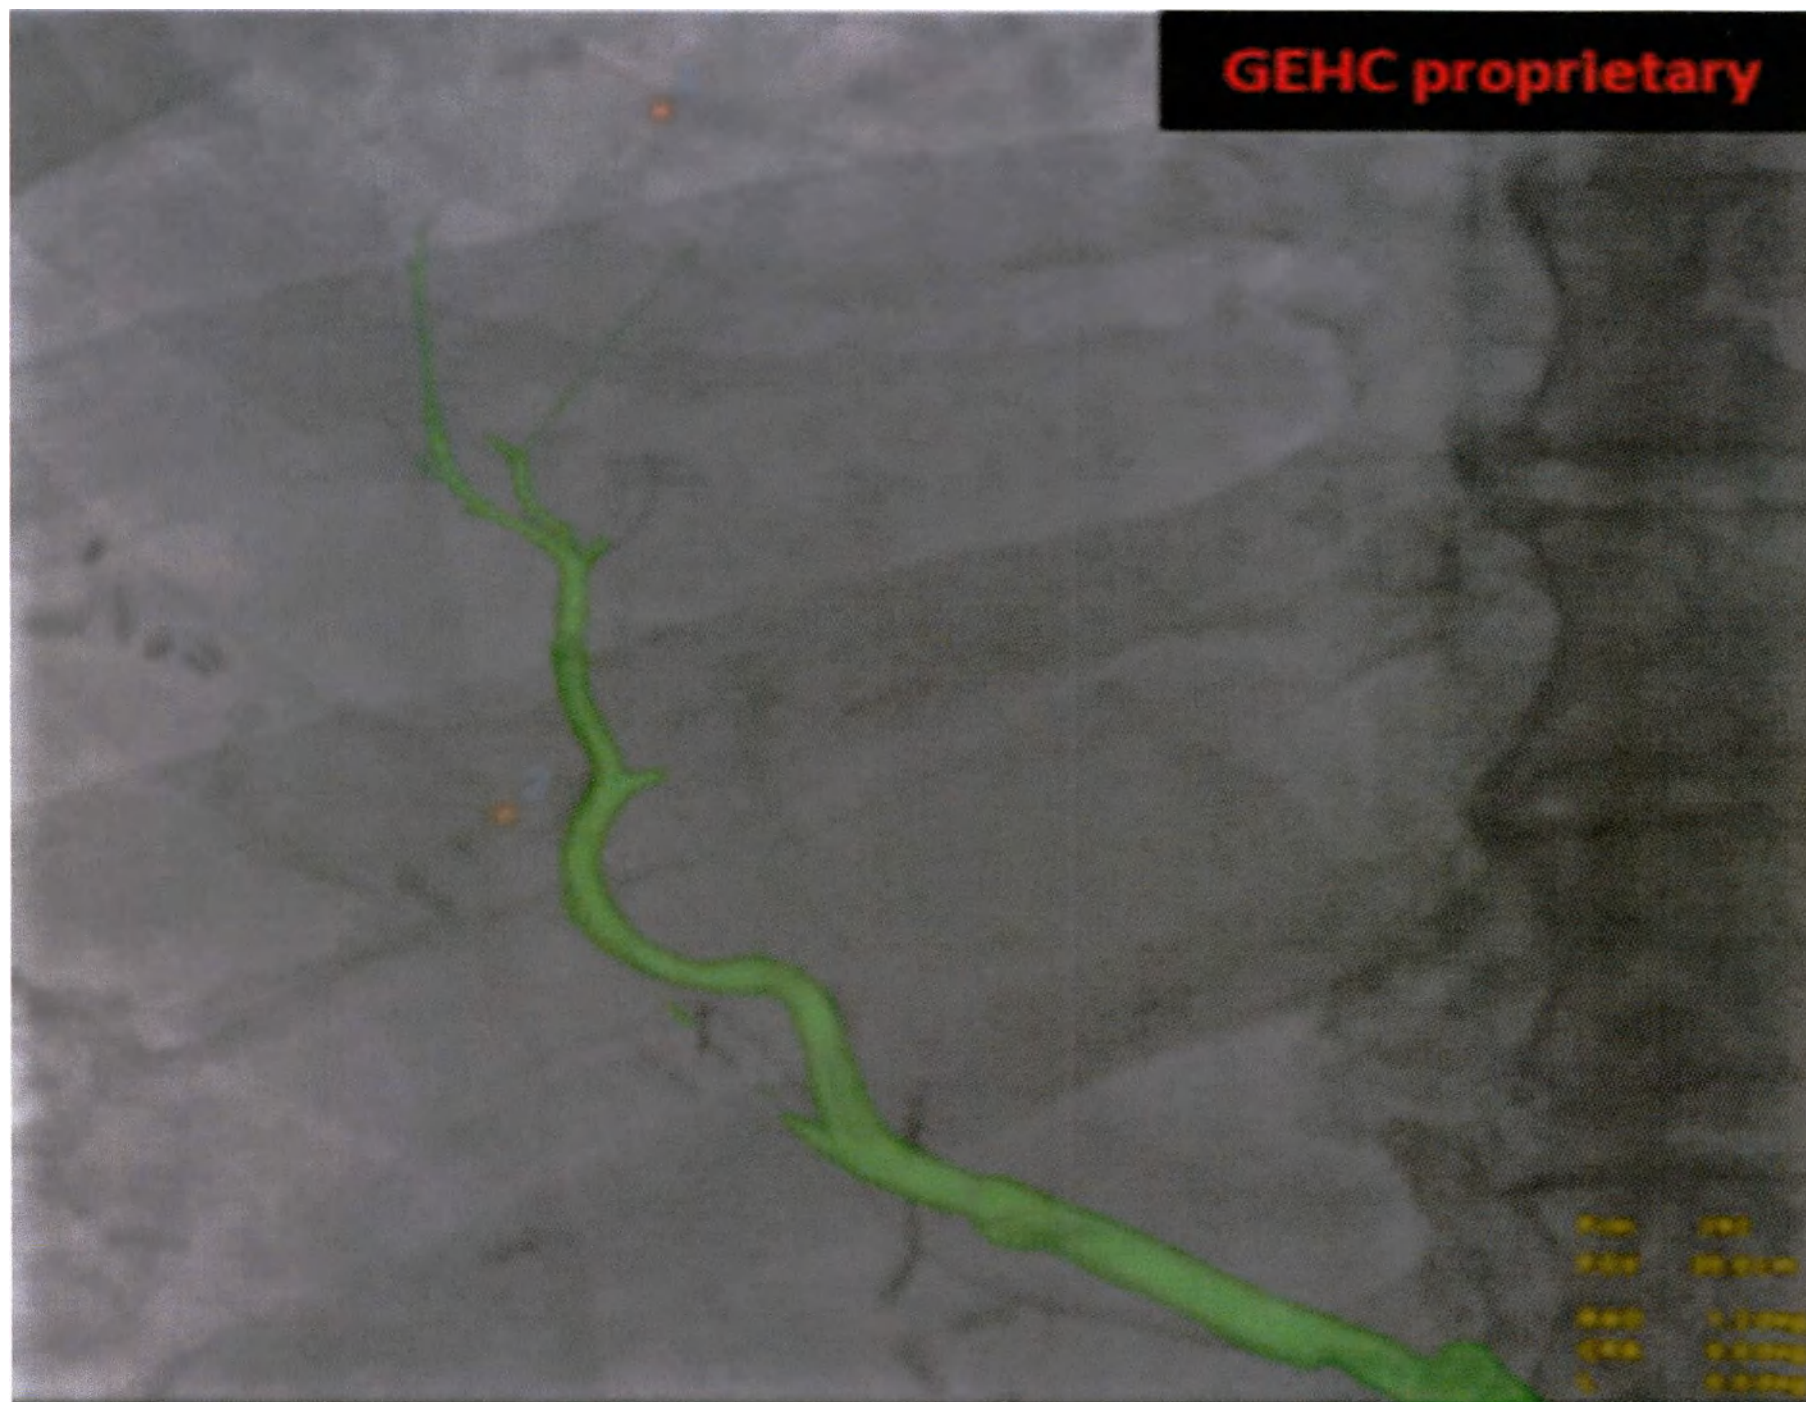


Рисунок 78. Программный модуль для автоматического определения питающих сосудов на трехмерном изображении с функцией совмещения с текущим рентгеноскопическим изображением

GEHC
proprietary



Рисунок 79. Программные модули трехмерной навигации рабочей станции АW

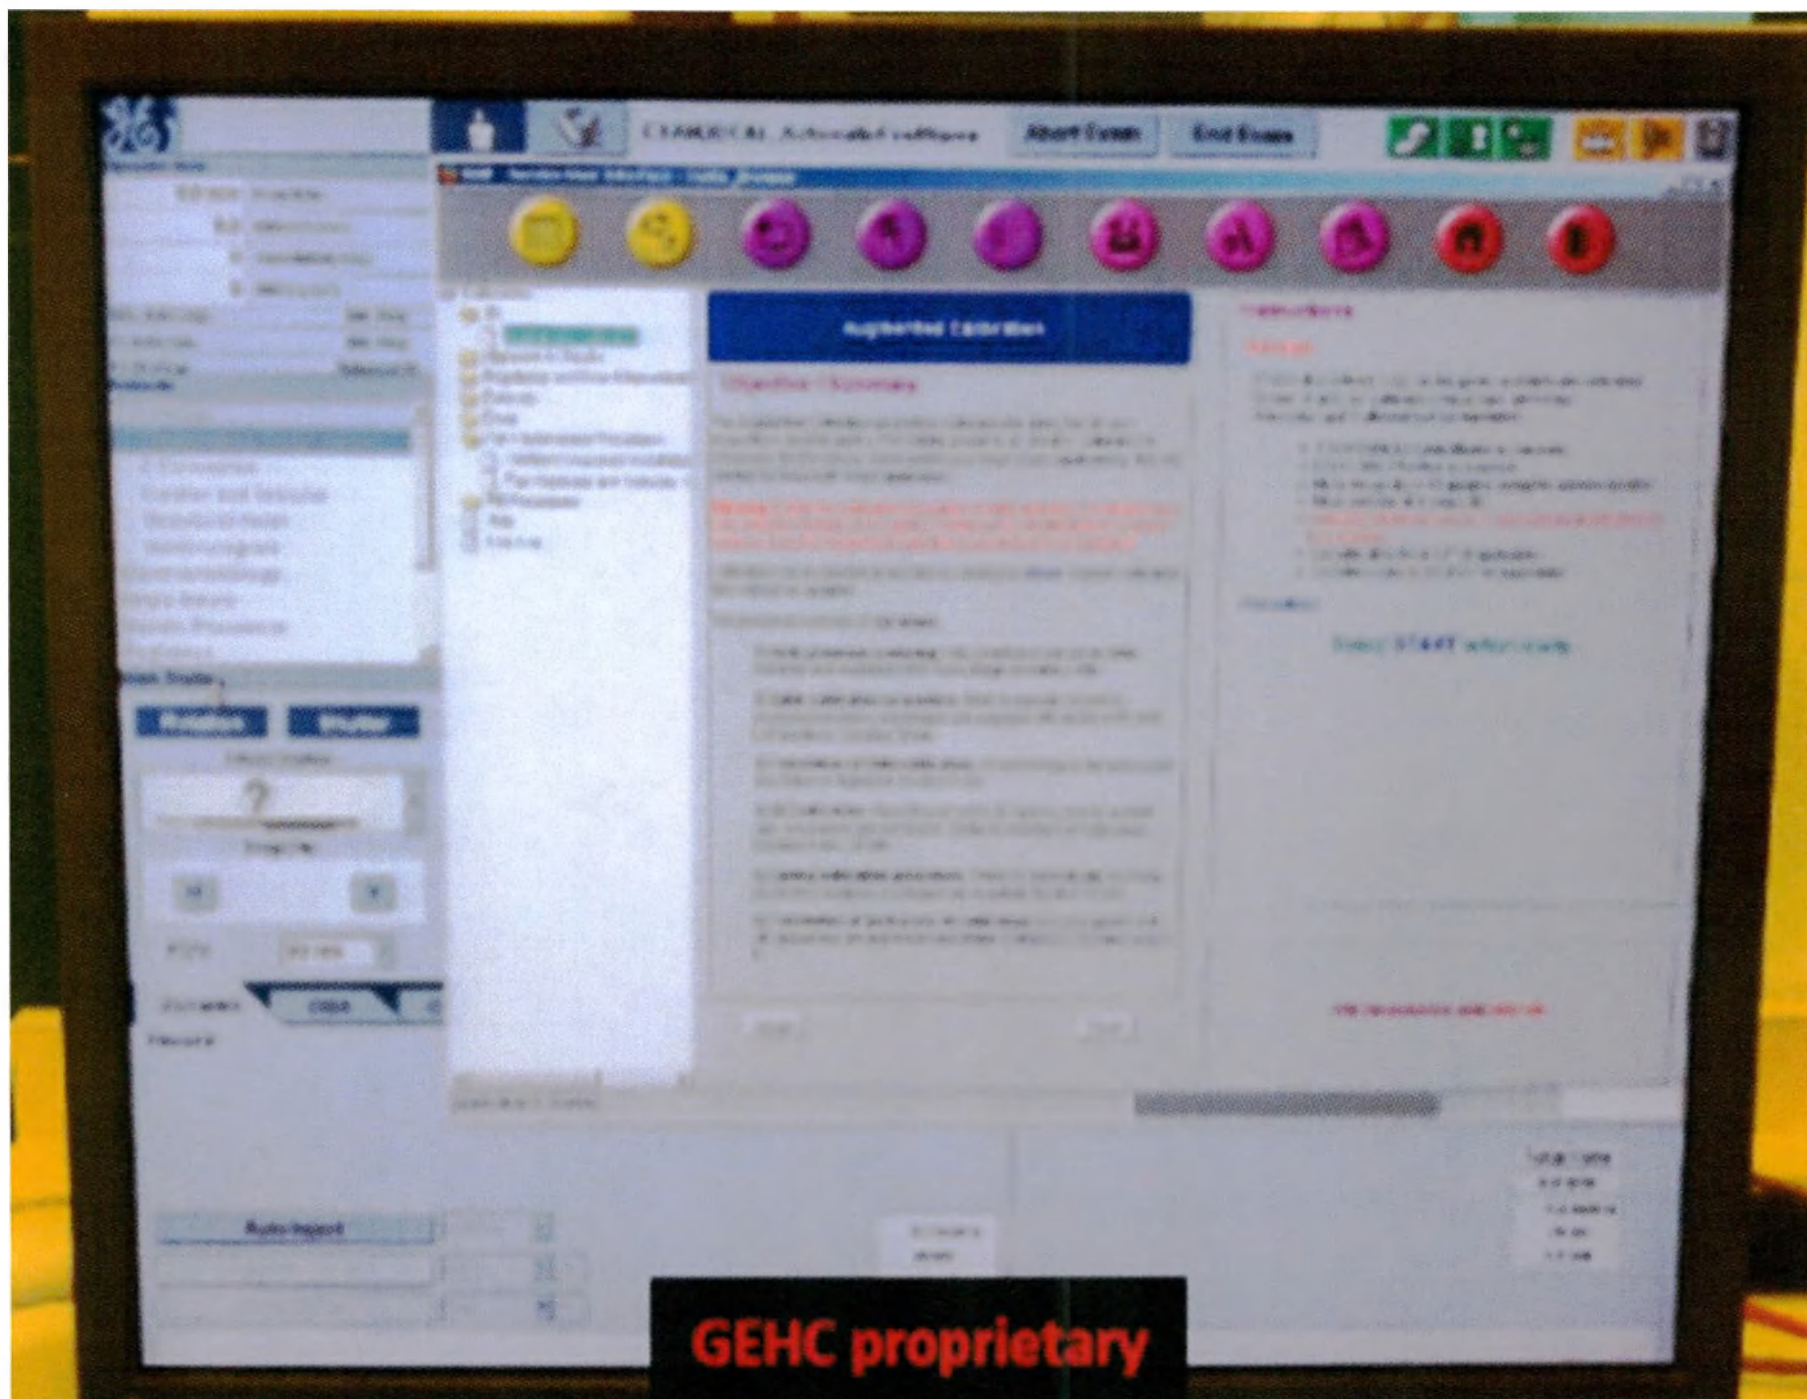


Рисунок 80. Модуль расширенной калибровки

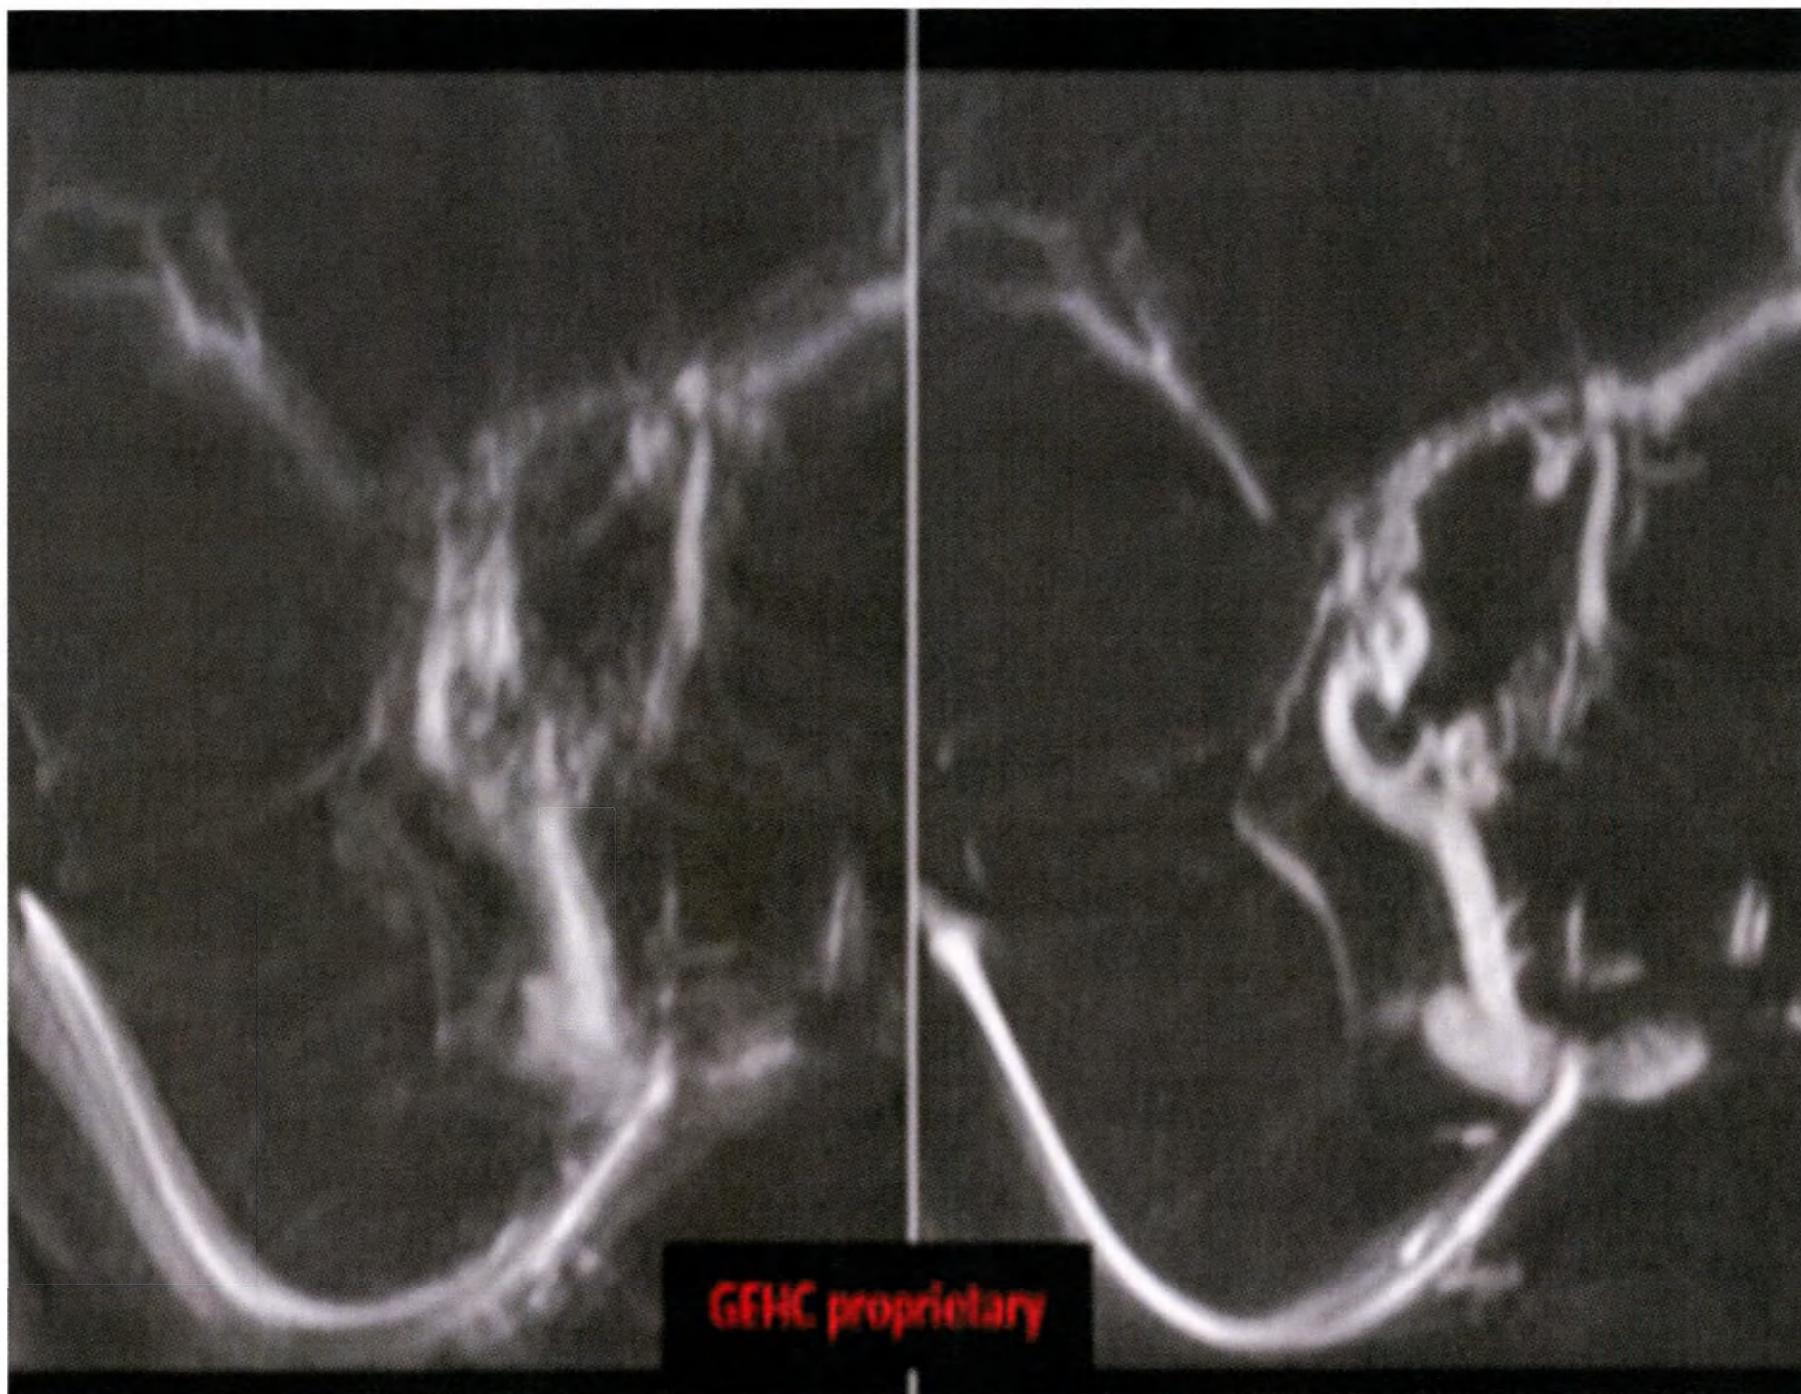


Рисунок 81. Программные приложения для подавления артефактов в объемных изображениях



Рисунок 82. Рабочие станции для просмотра, обработки и архивации медицинских изображений



Рисунок 83. Программные модули для рабочей станции

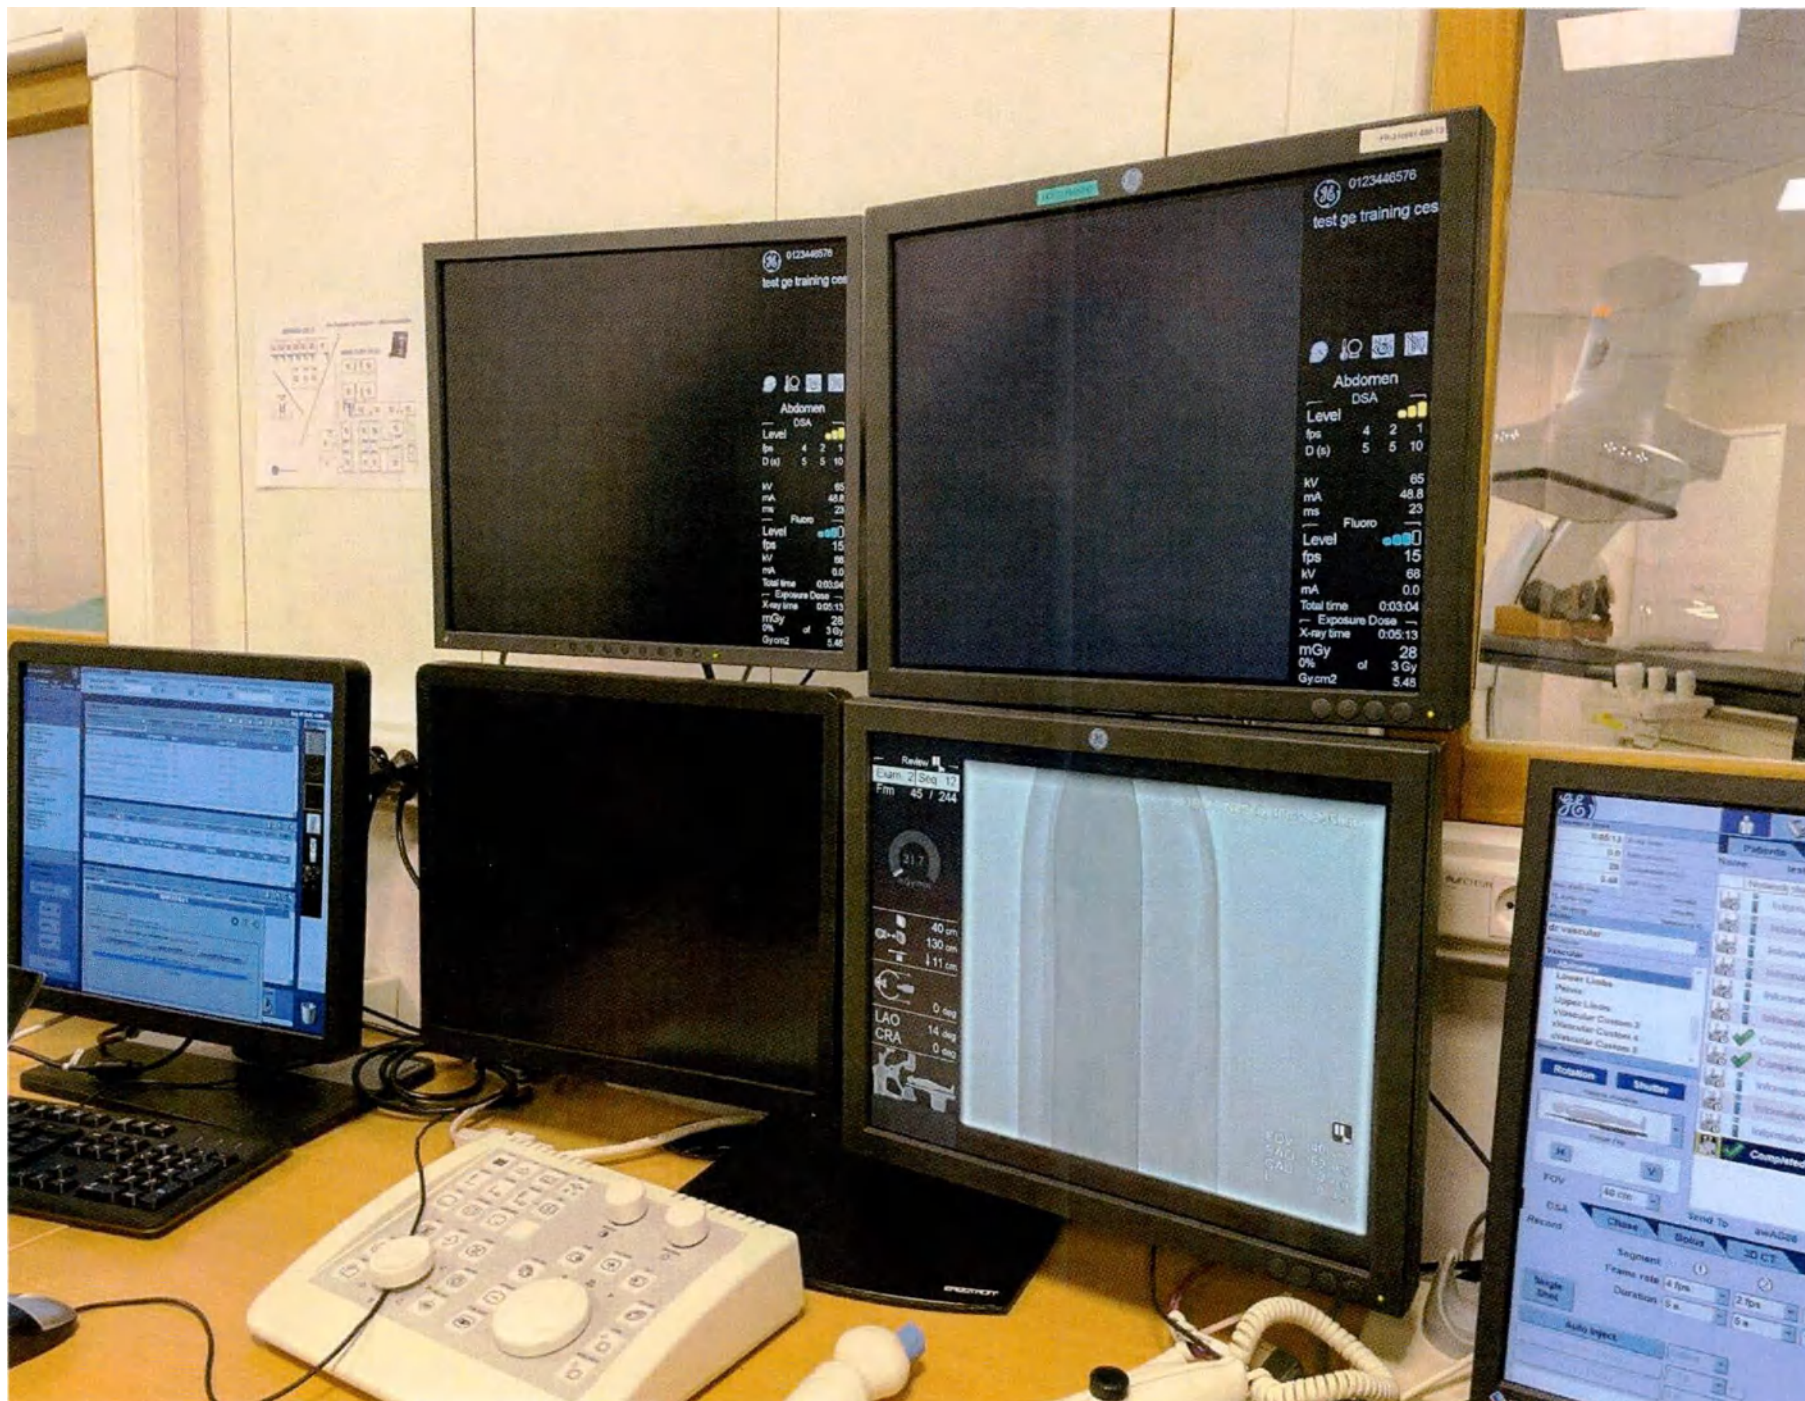


Рисунок 84. Специальные медицинские мониторы постоянного изображения

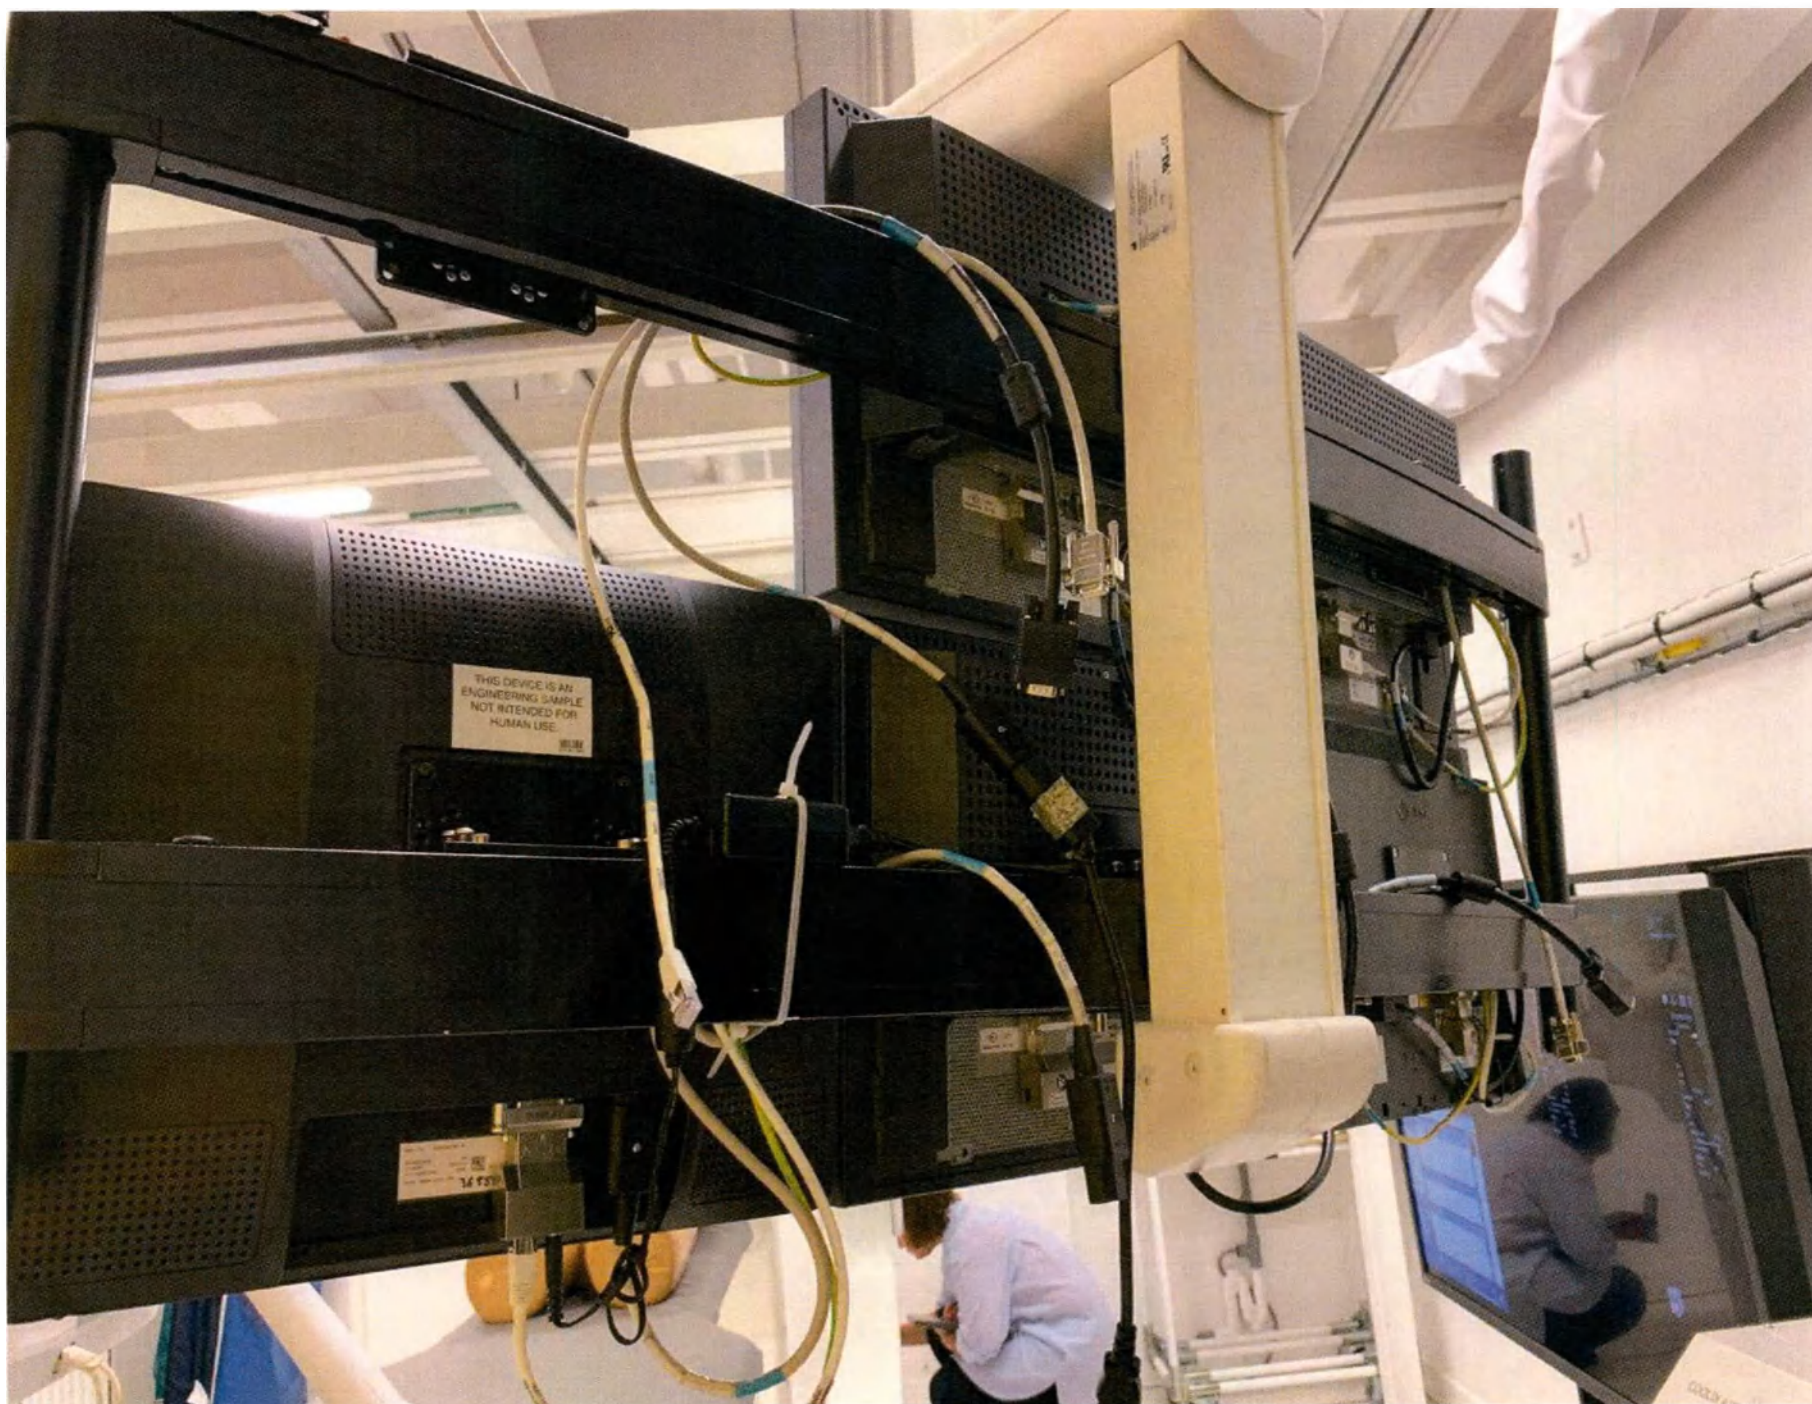


Рисунок 85. Кабели для медицинских мониторов

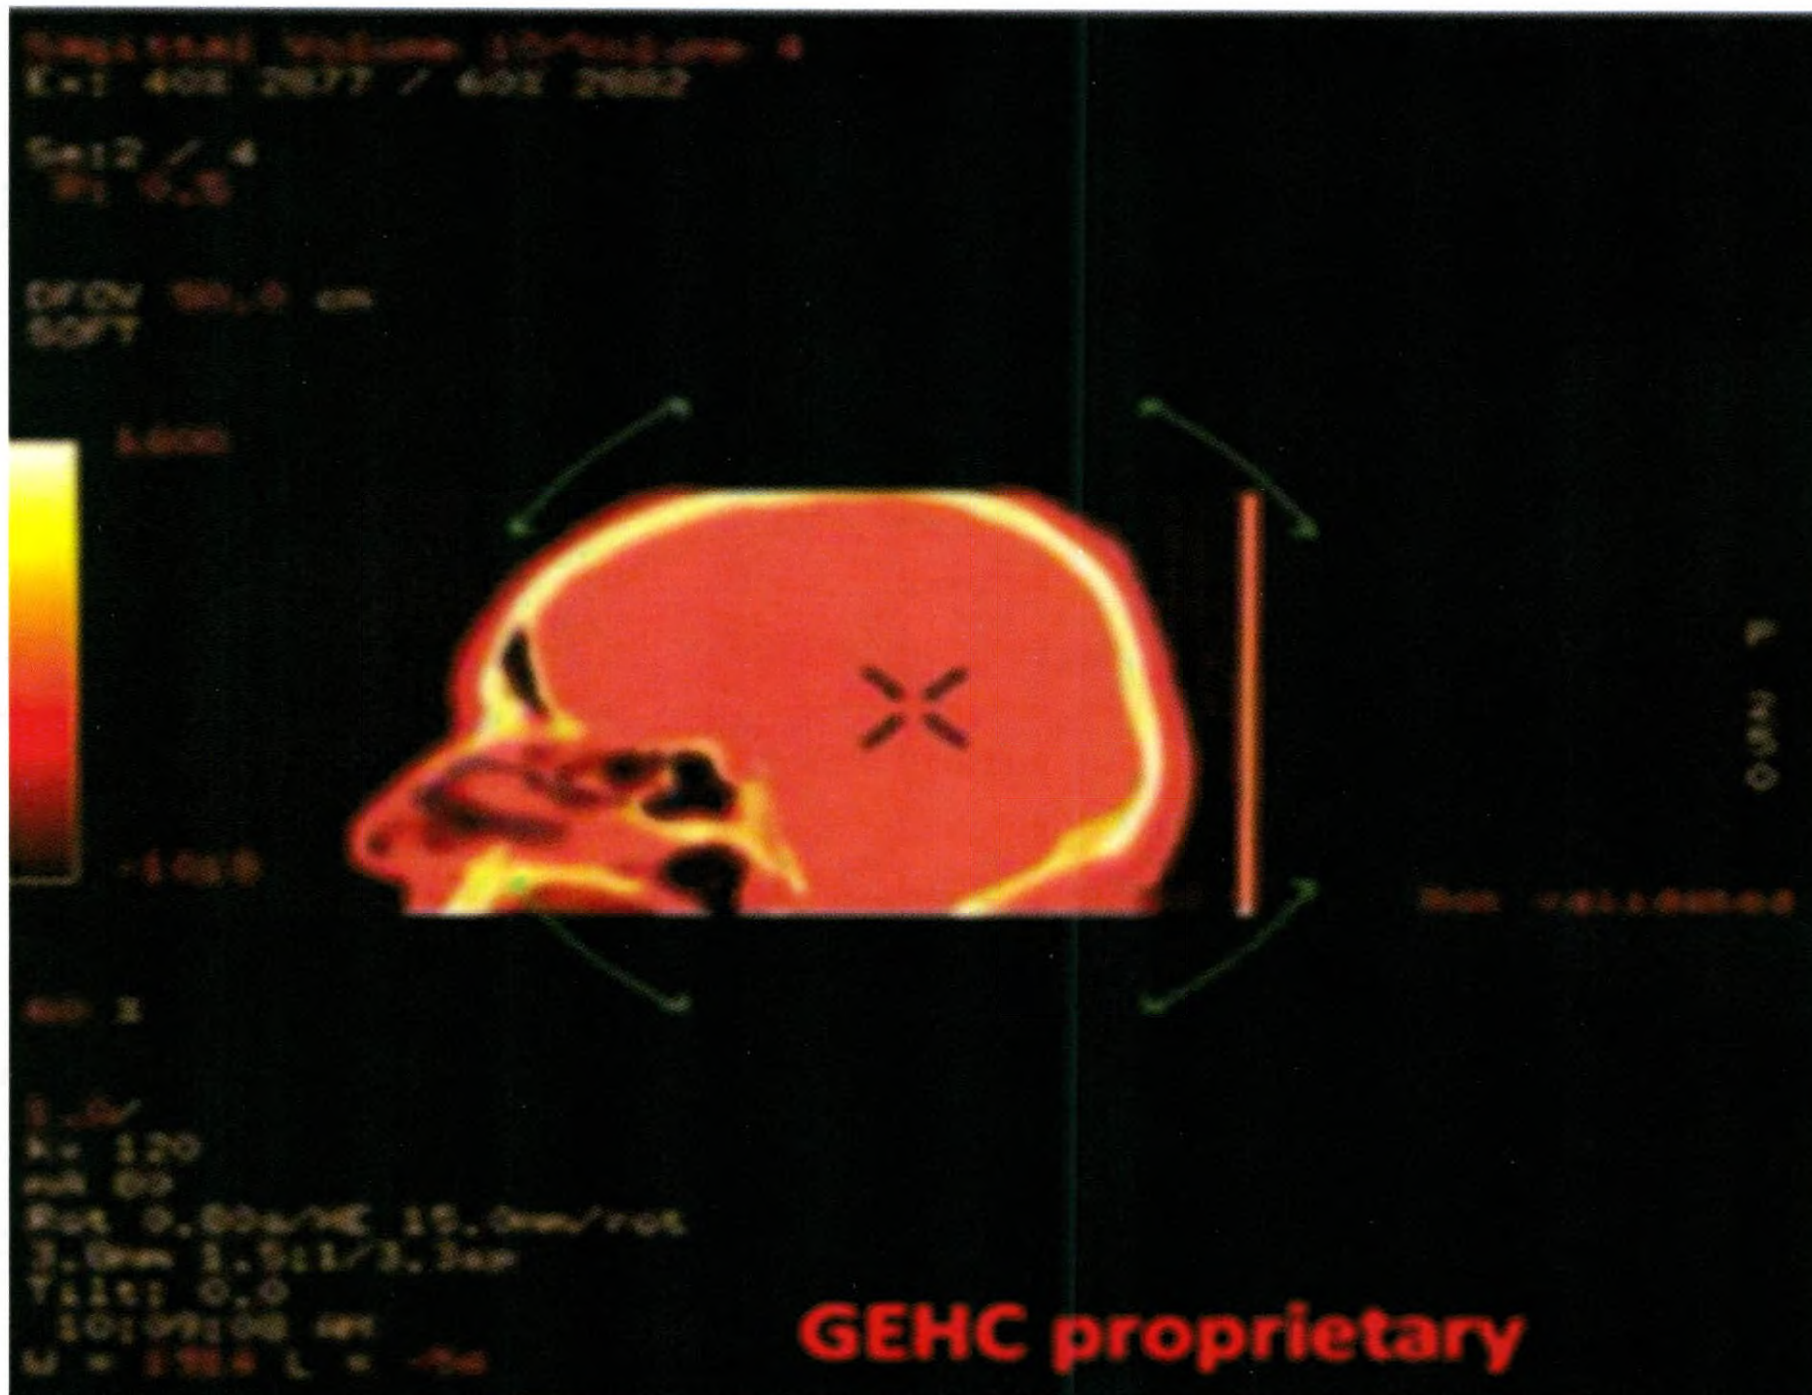


Рисунок 86. Программный модуль совмещения изображений

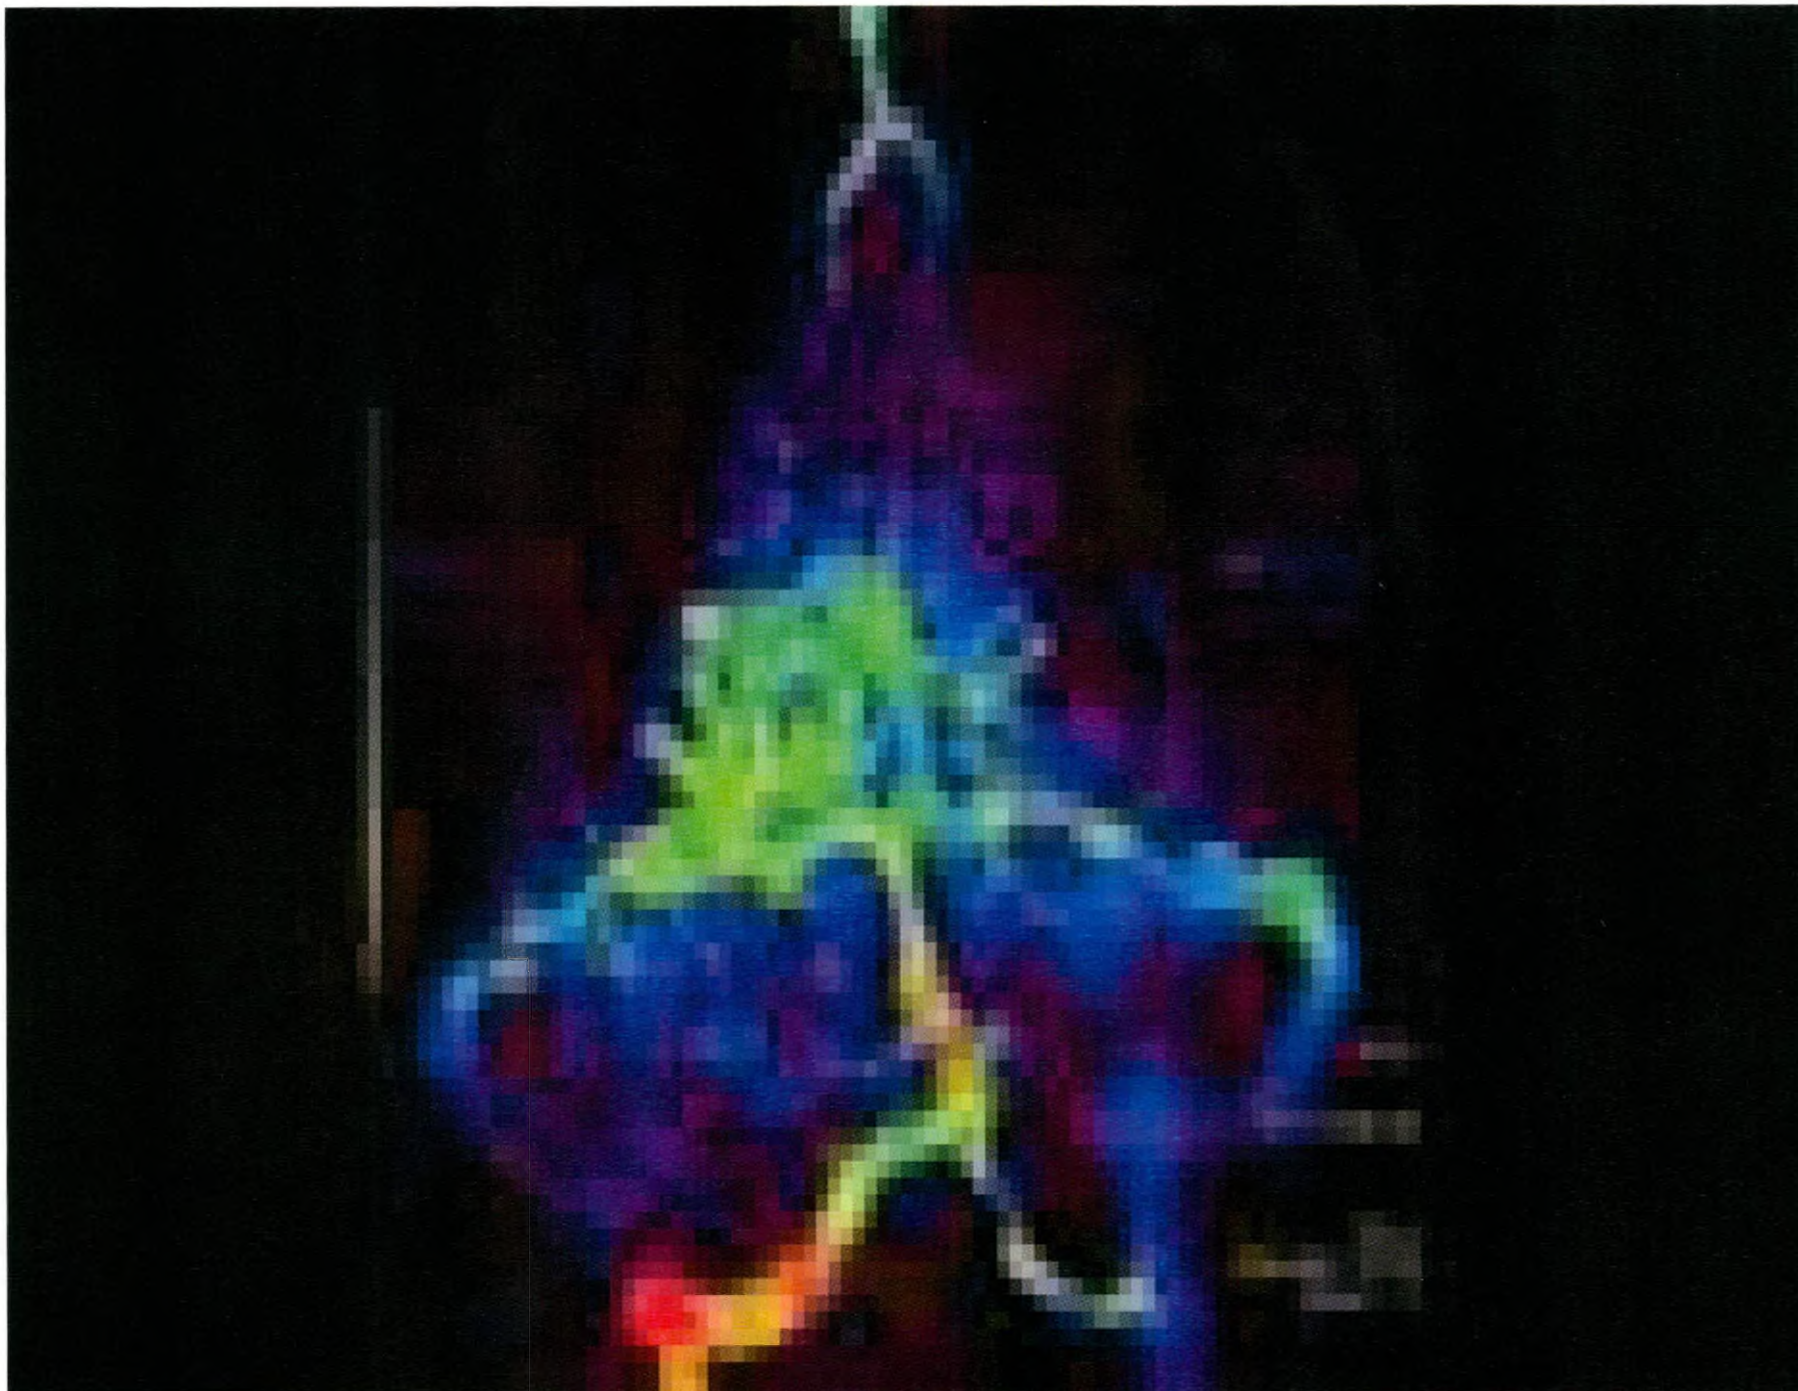


Рисунок 87. Программный модуль для получения суммационных изображений

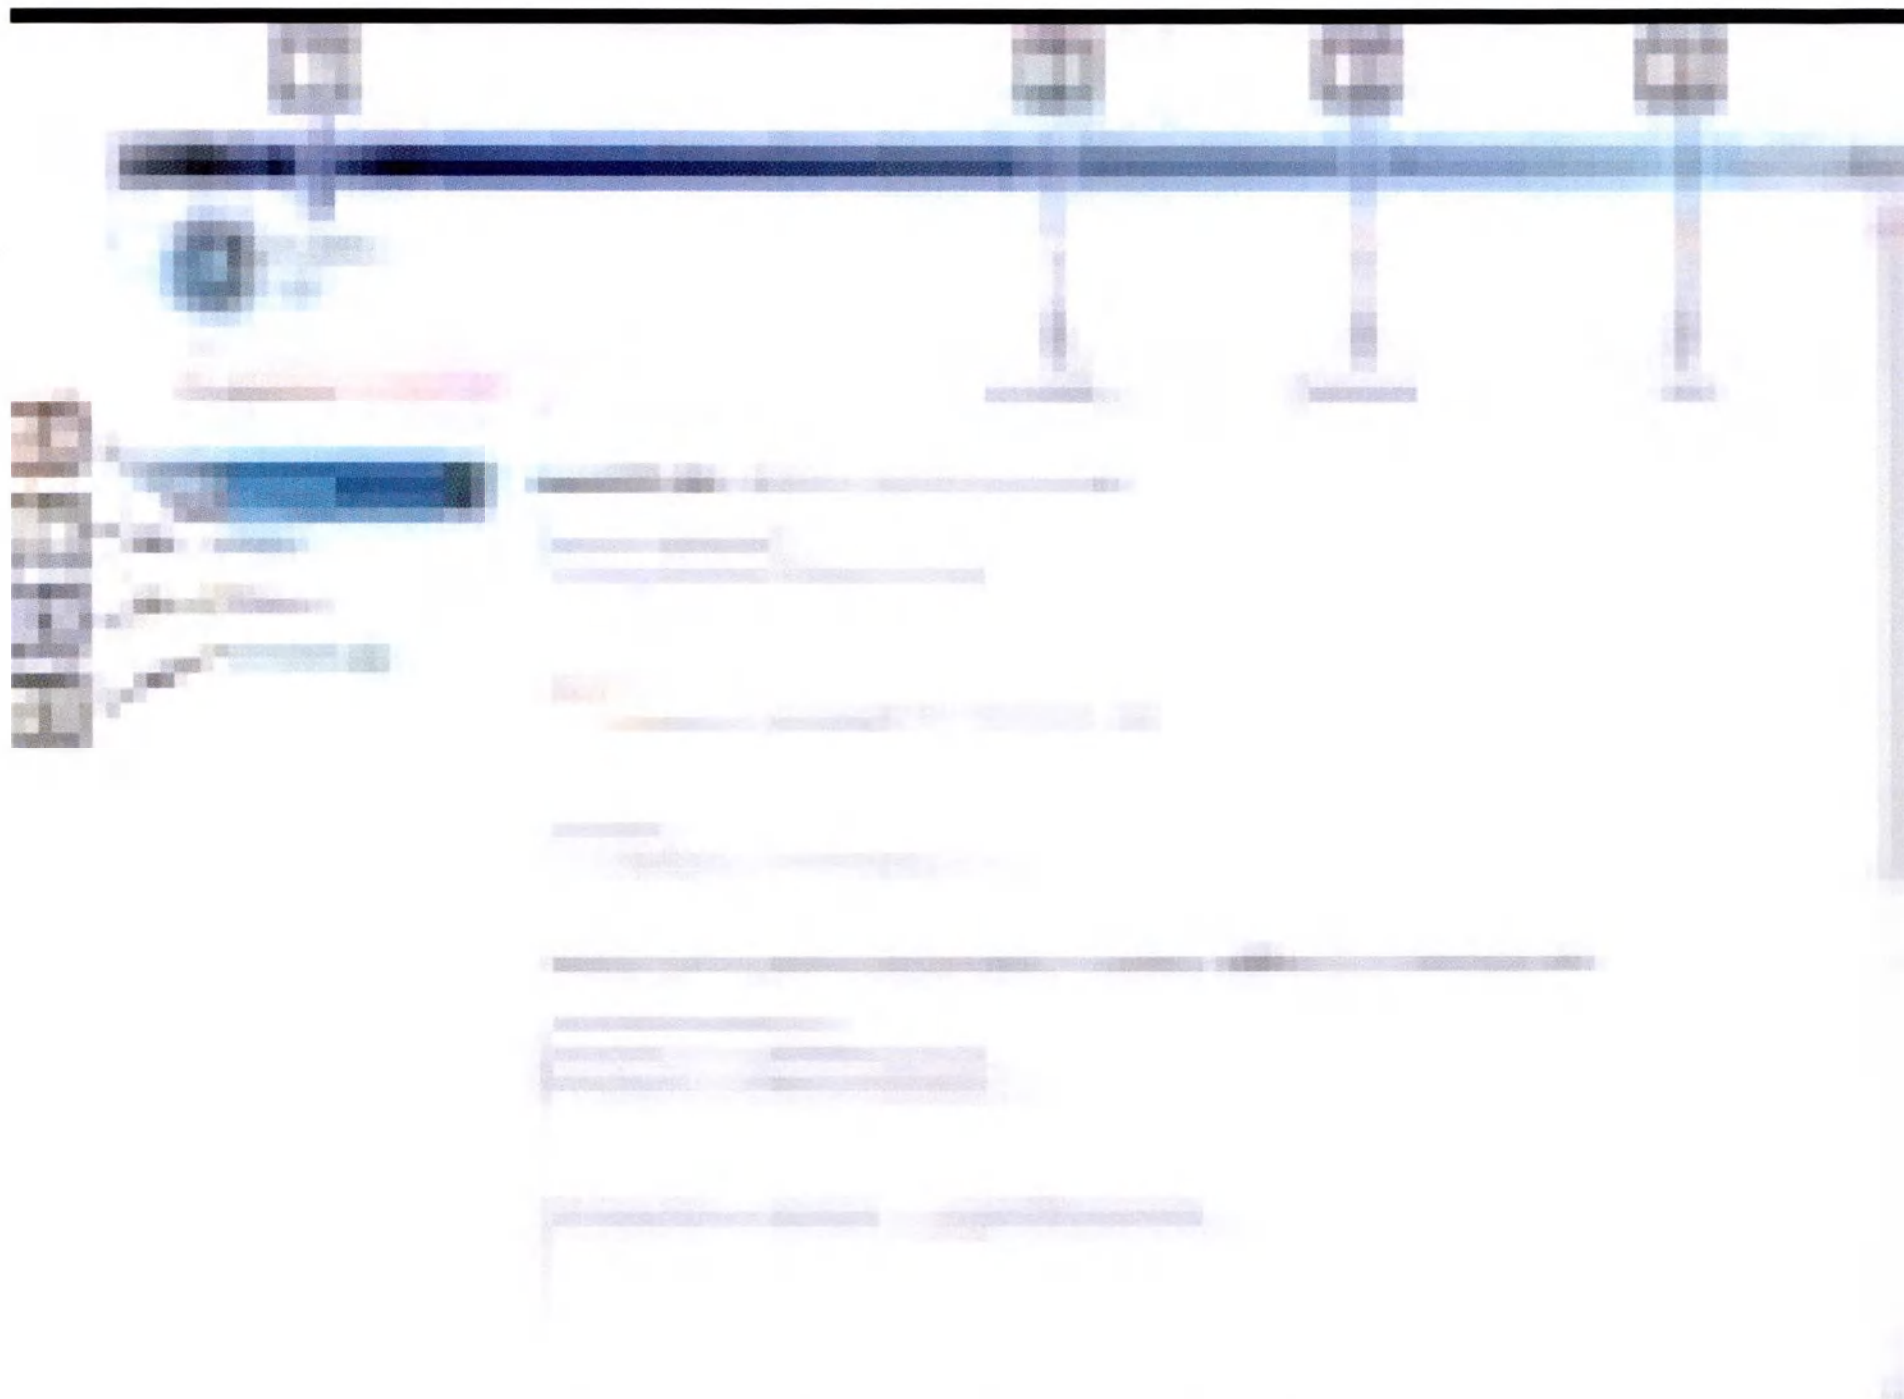


Рисунок 88. Программный модуль для удаленного доступа к рабочей станции

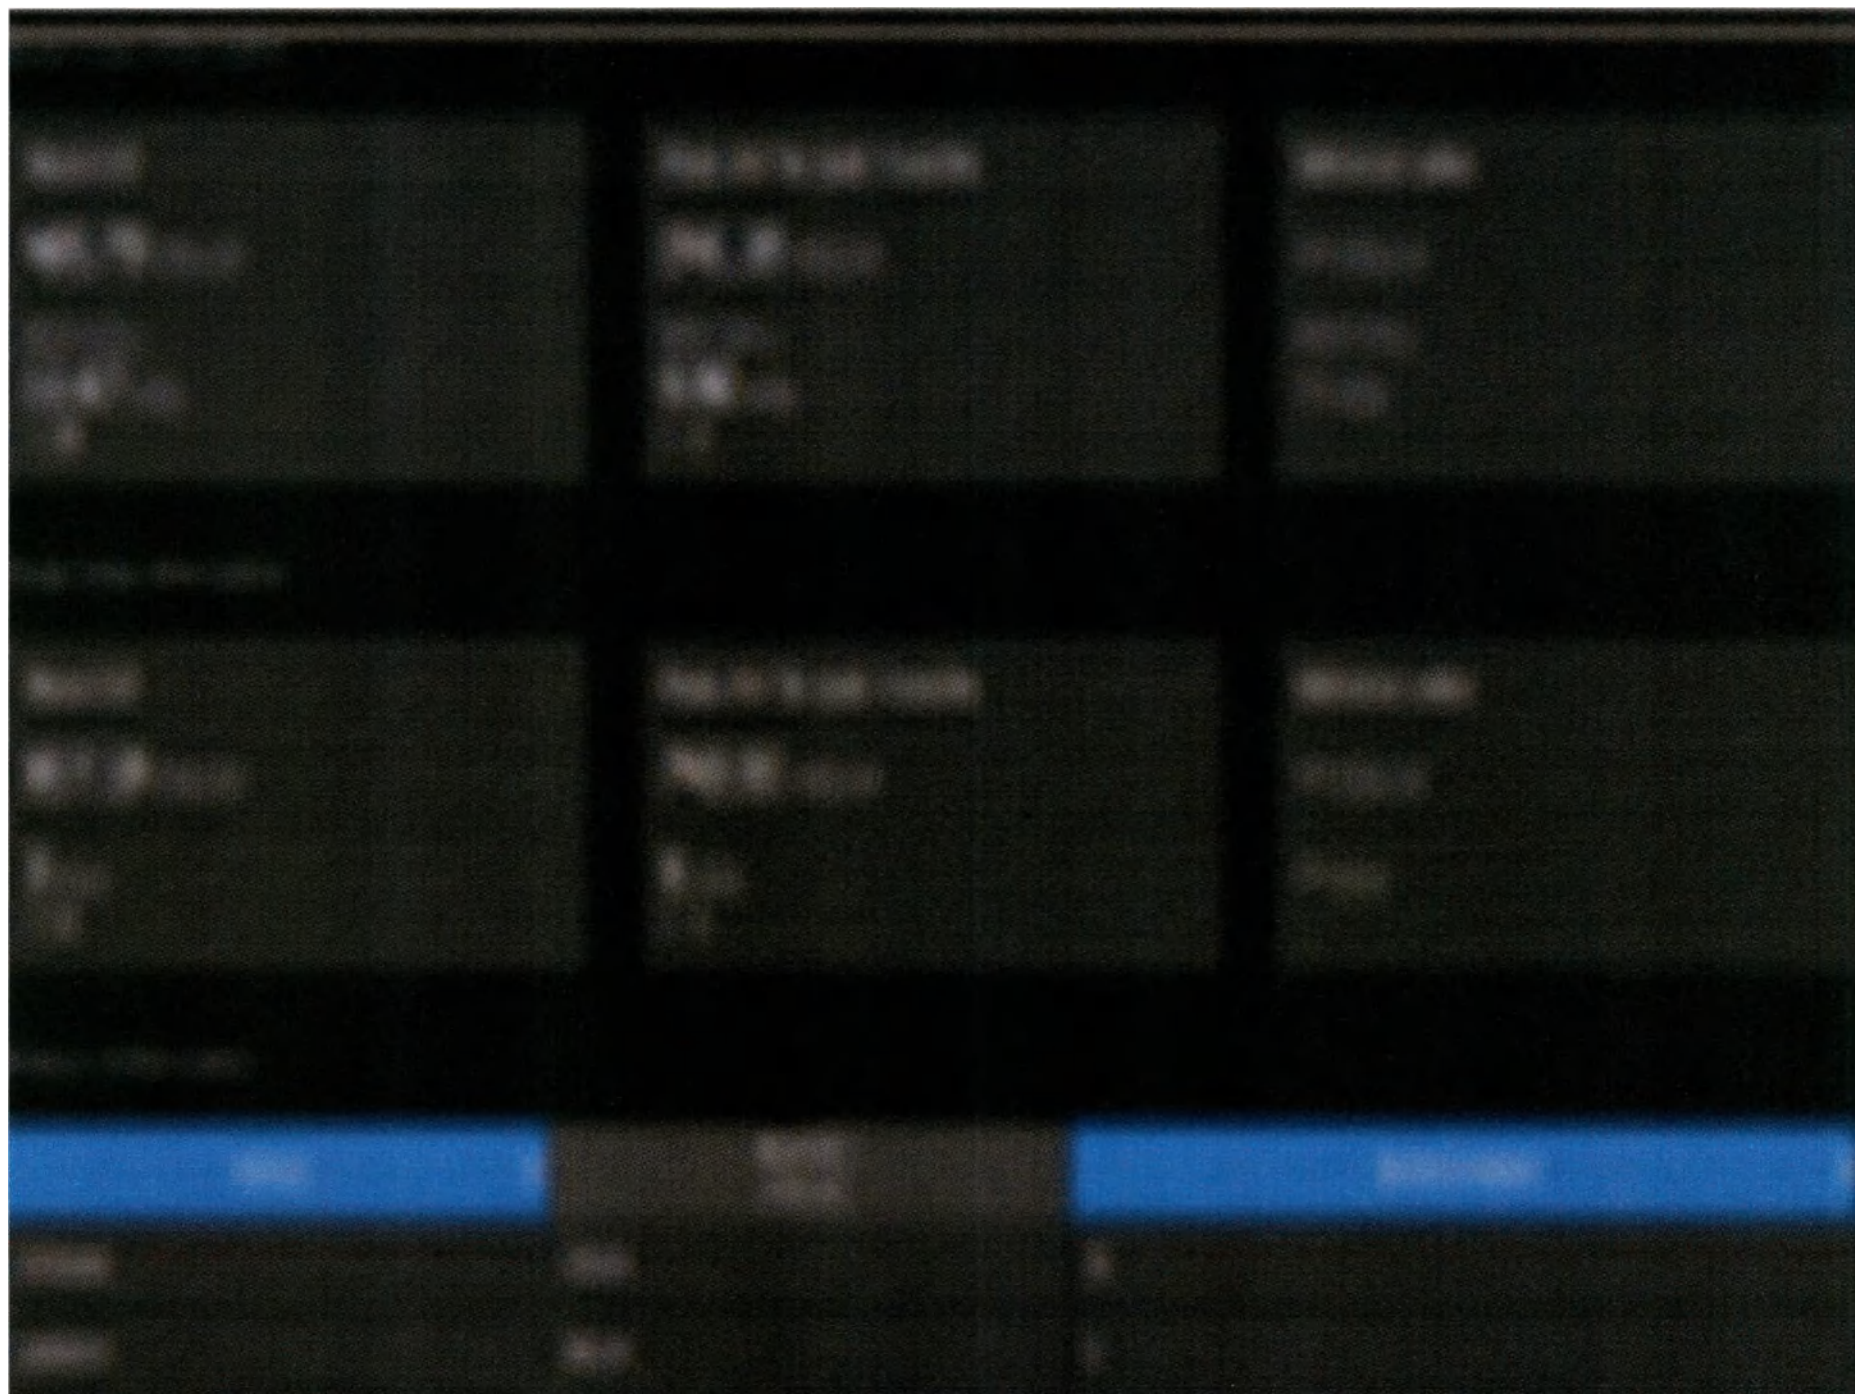


Рисунок 89. Программный пакет для расчета уровня лучевой нагрузки



Рисунок 90. Интерфейс для подключения к внешним устройствам



Рисунок 91. Кабель для устройства автоматического для введения контрастного вещества



Рисунок 92. Устройство автоматическое для введения контрастного вещества



Рисунок 93. Шприцы к автоматическому устройству для введения контрастного вещества



Рисунок 94. Линии пациента к автоматическому устройству для введения контрастного вещества



Рисунок 95. Экран для защиты нижней части тела от рентгеновского излучения

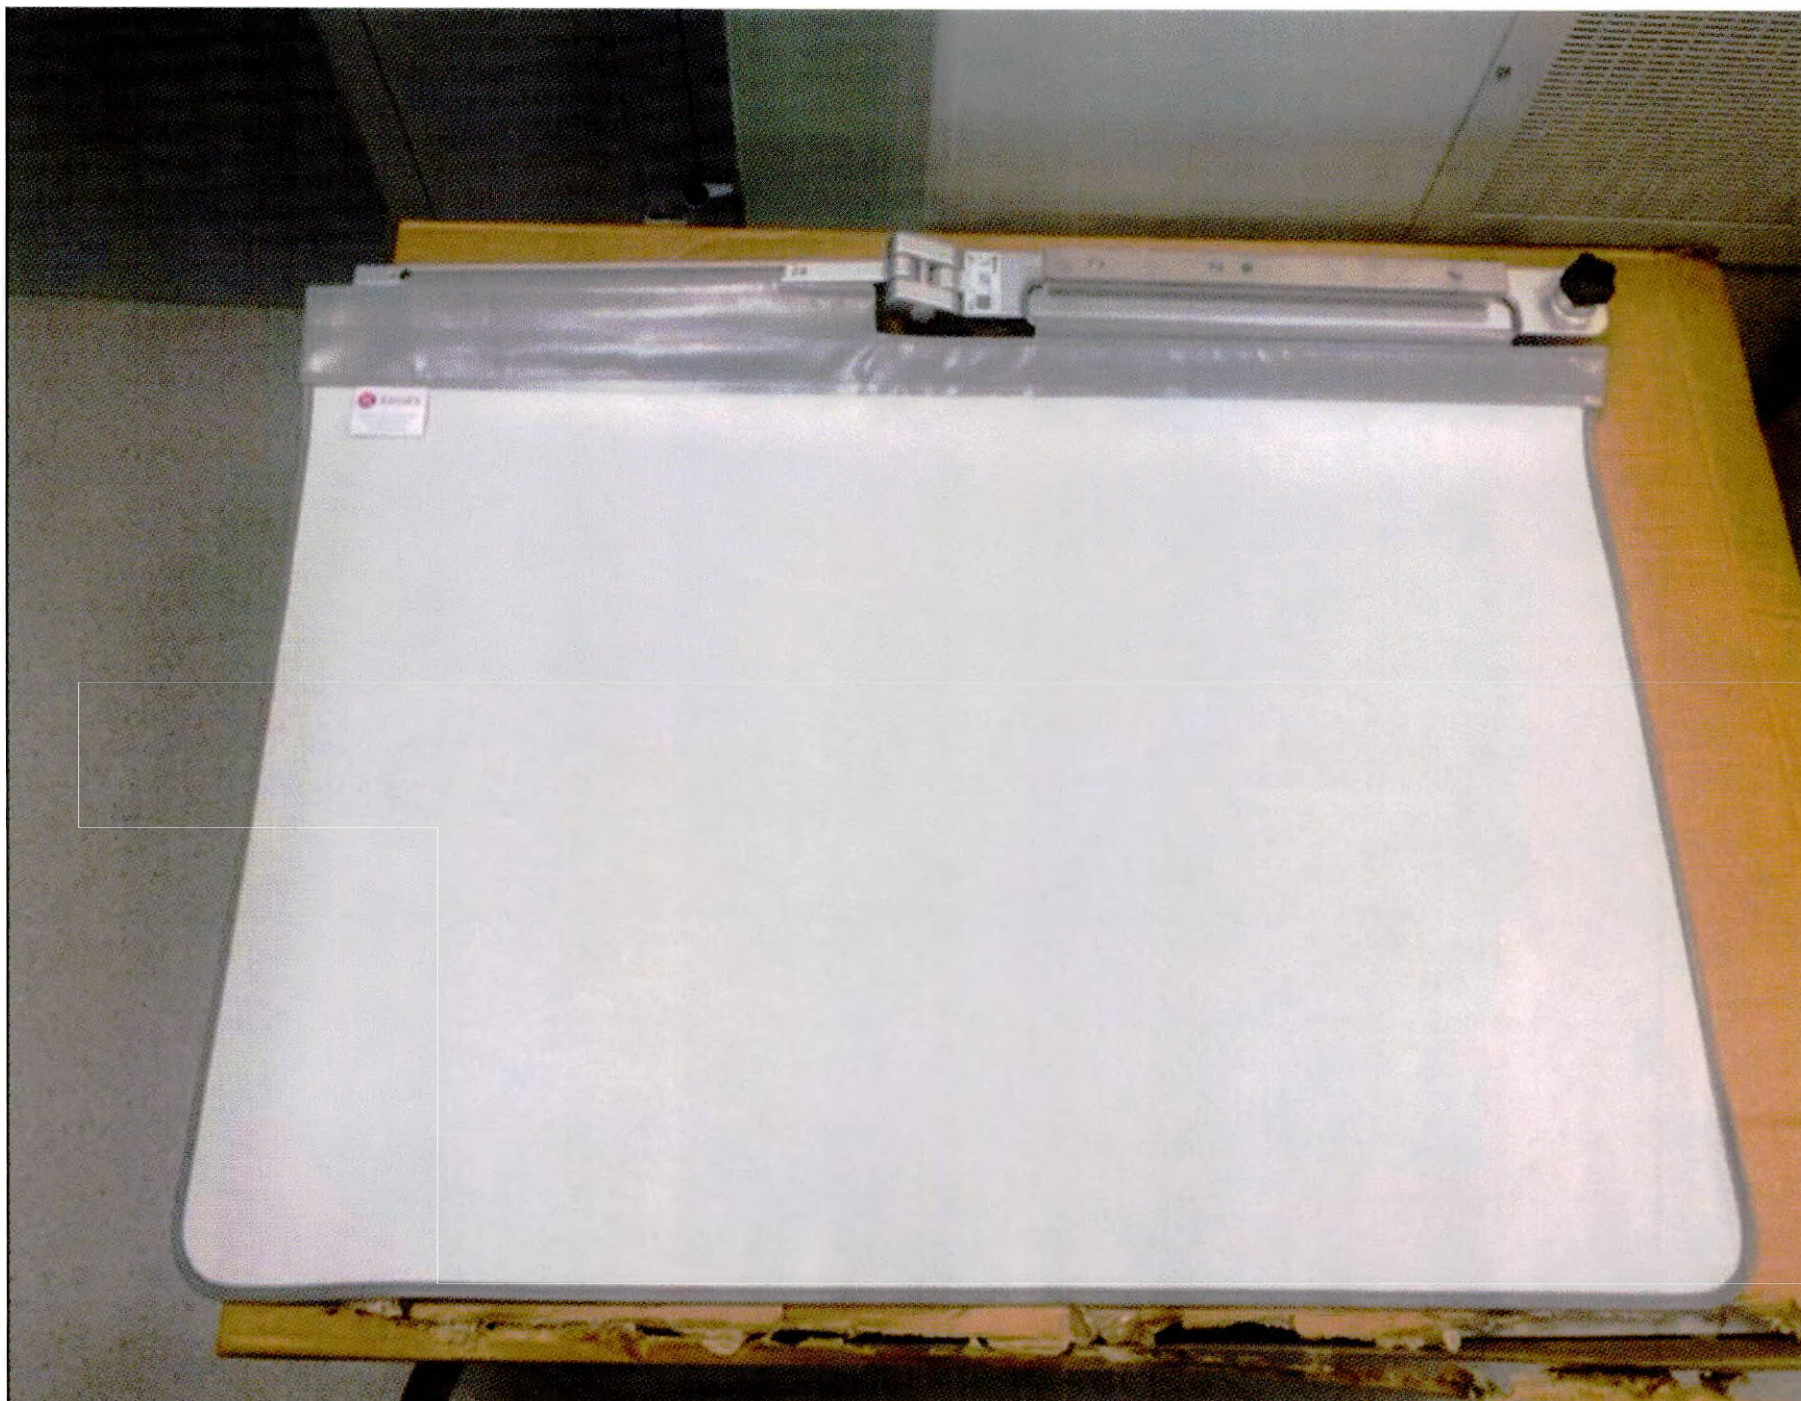


Рисунок 96. Экран для защиты нижней части тела двойной с функцией поворота



Рисунок 97. Дополнительная часть для расширения в высоту экрана для защиты нижней части тела от рентгеновского излучения



Рисунок 98. Устройство для монтажа рентгенозащитной ширмы и хирургического светильника потолочного крепления



Рисунок 99. Хирургический светильник высокой интенсивности с потолочным креплением



Рисунок 100. Рентгенозащита для щитовидной железы



Рисунок 101. рентгенозащитные очки



Рисунок 102. Рентгенозащитные юбки



Рисунок 103. Рентгенозащитные накидки



Рисунок 104. Хирургические защитные фартуки



Рисунок 105. Рентгенозащитные стекла с рамой



Рисунок 106. Рентгенозащитные ширмы для нижней части тела



Рисунок 107. Мобильная рентгенозащитная кабина

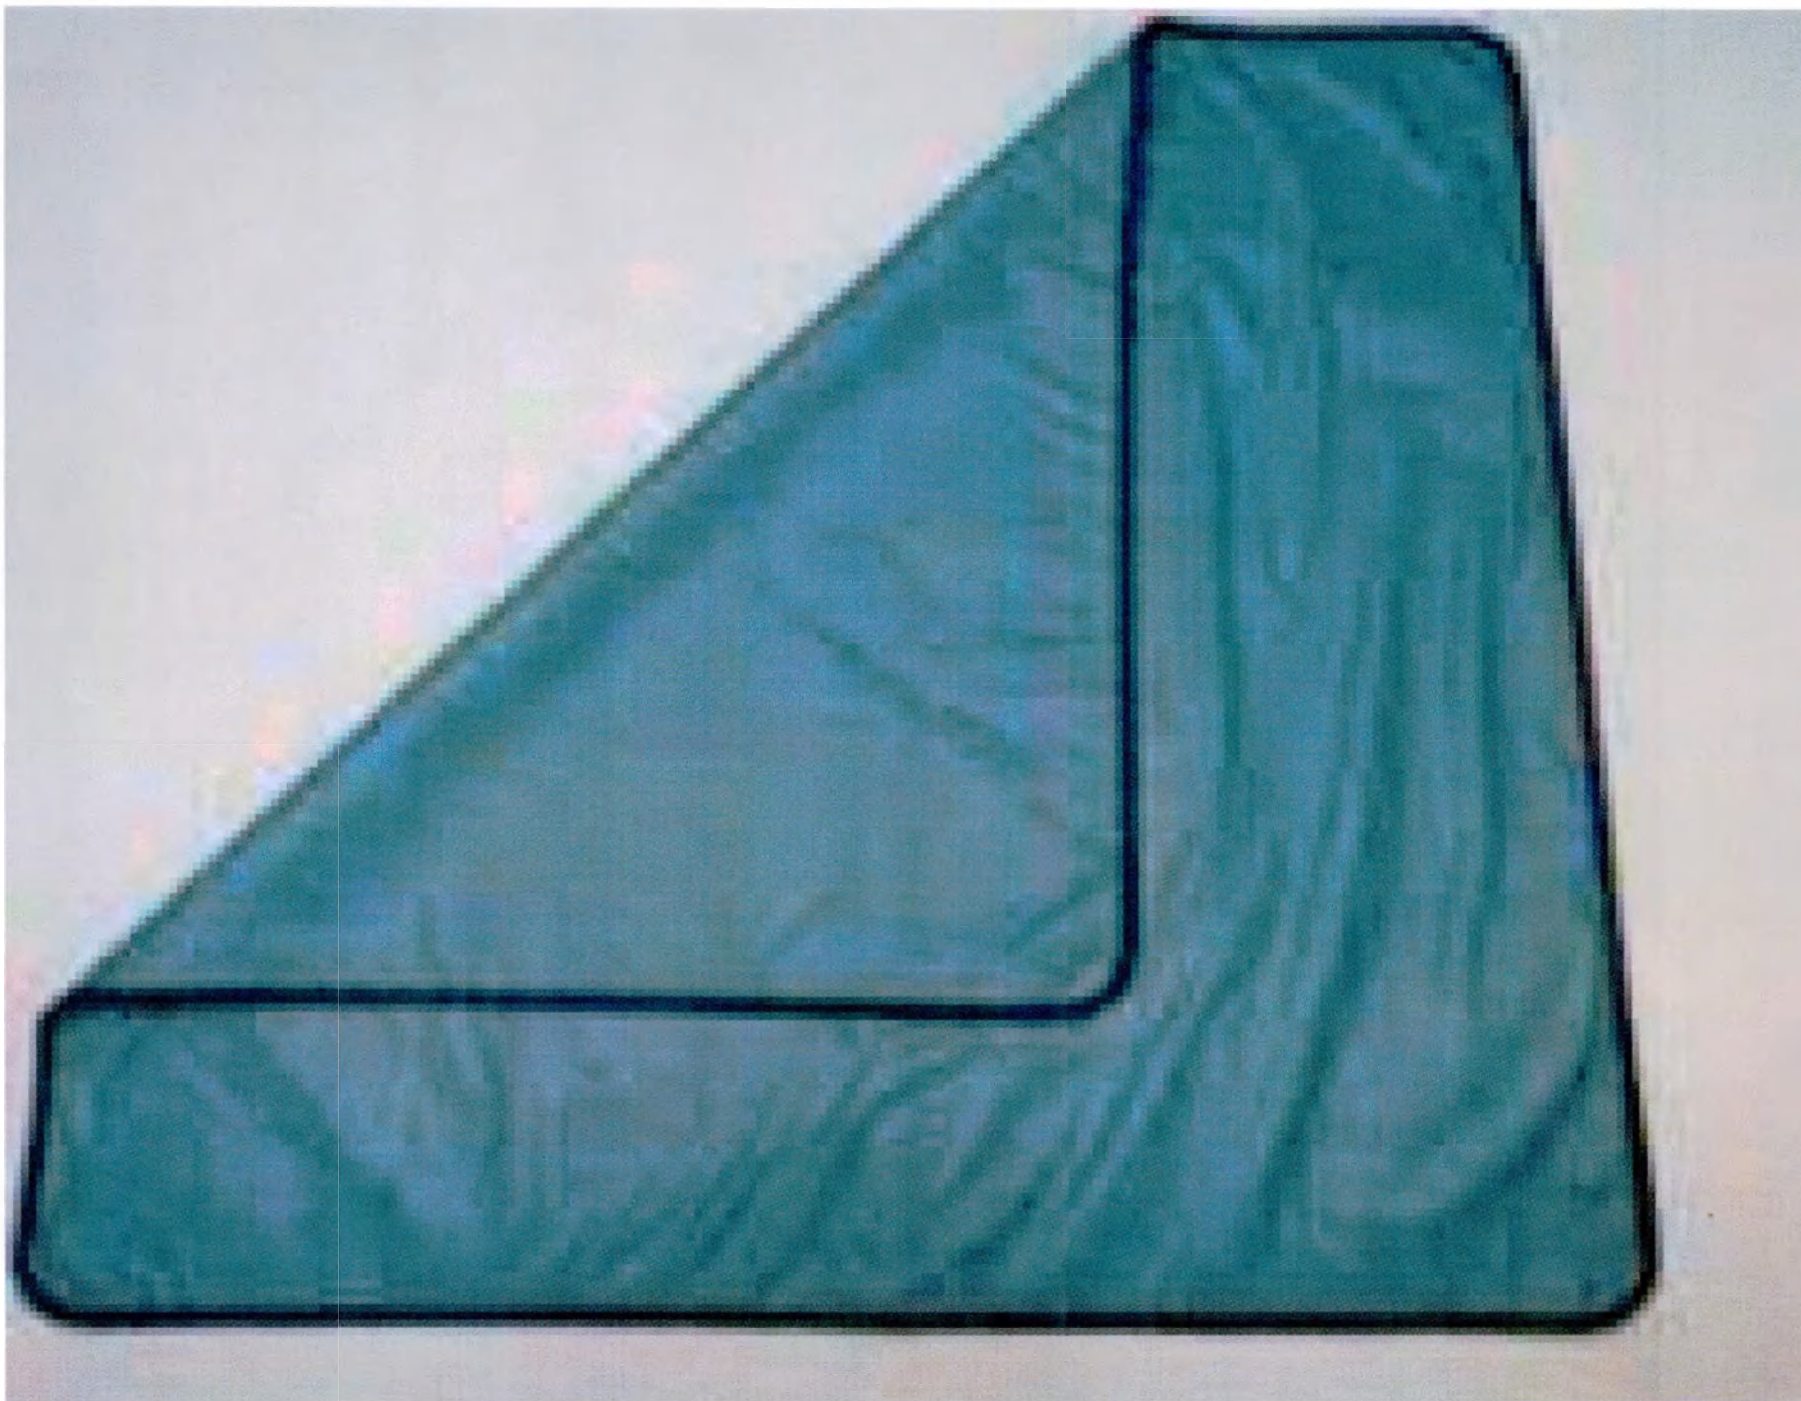


Рисунок 108. Защита пациента от рентгеновского излучения



Рисунок 109. Съемный рентгенозащитный экран для верхней части тела



Рисунок 110. Двойной поворотный рентгенозащитный экран верхней части тела



Рисунок 111. Экран защиты от рентгеновского излучения



Рисунок 112. Рентгенозащитная ширма потолочного крепления

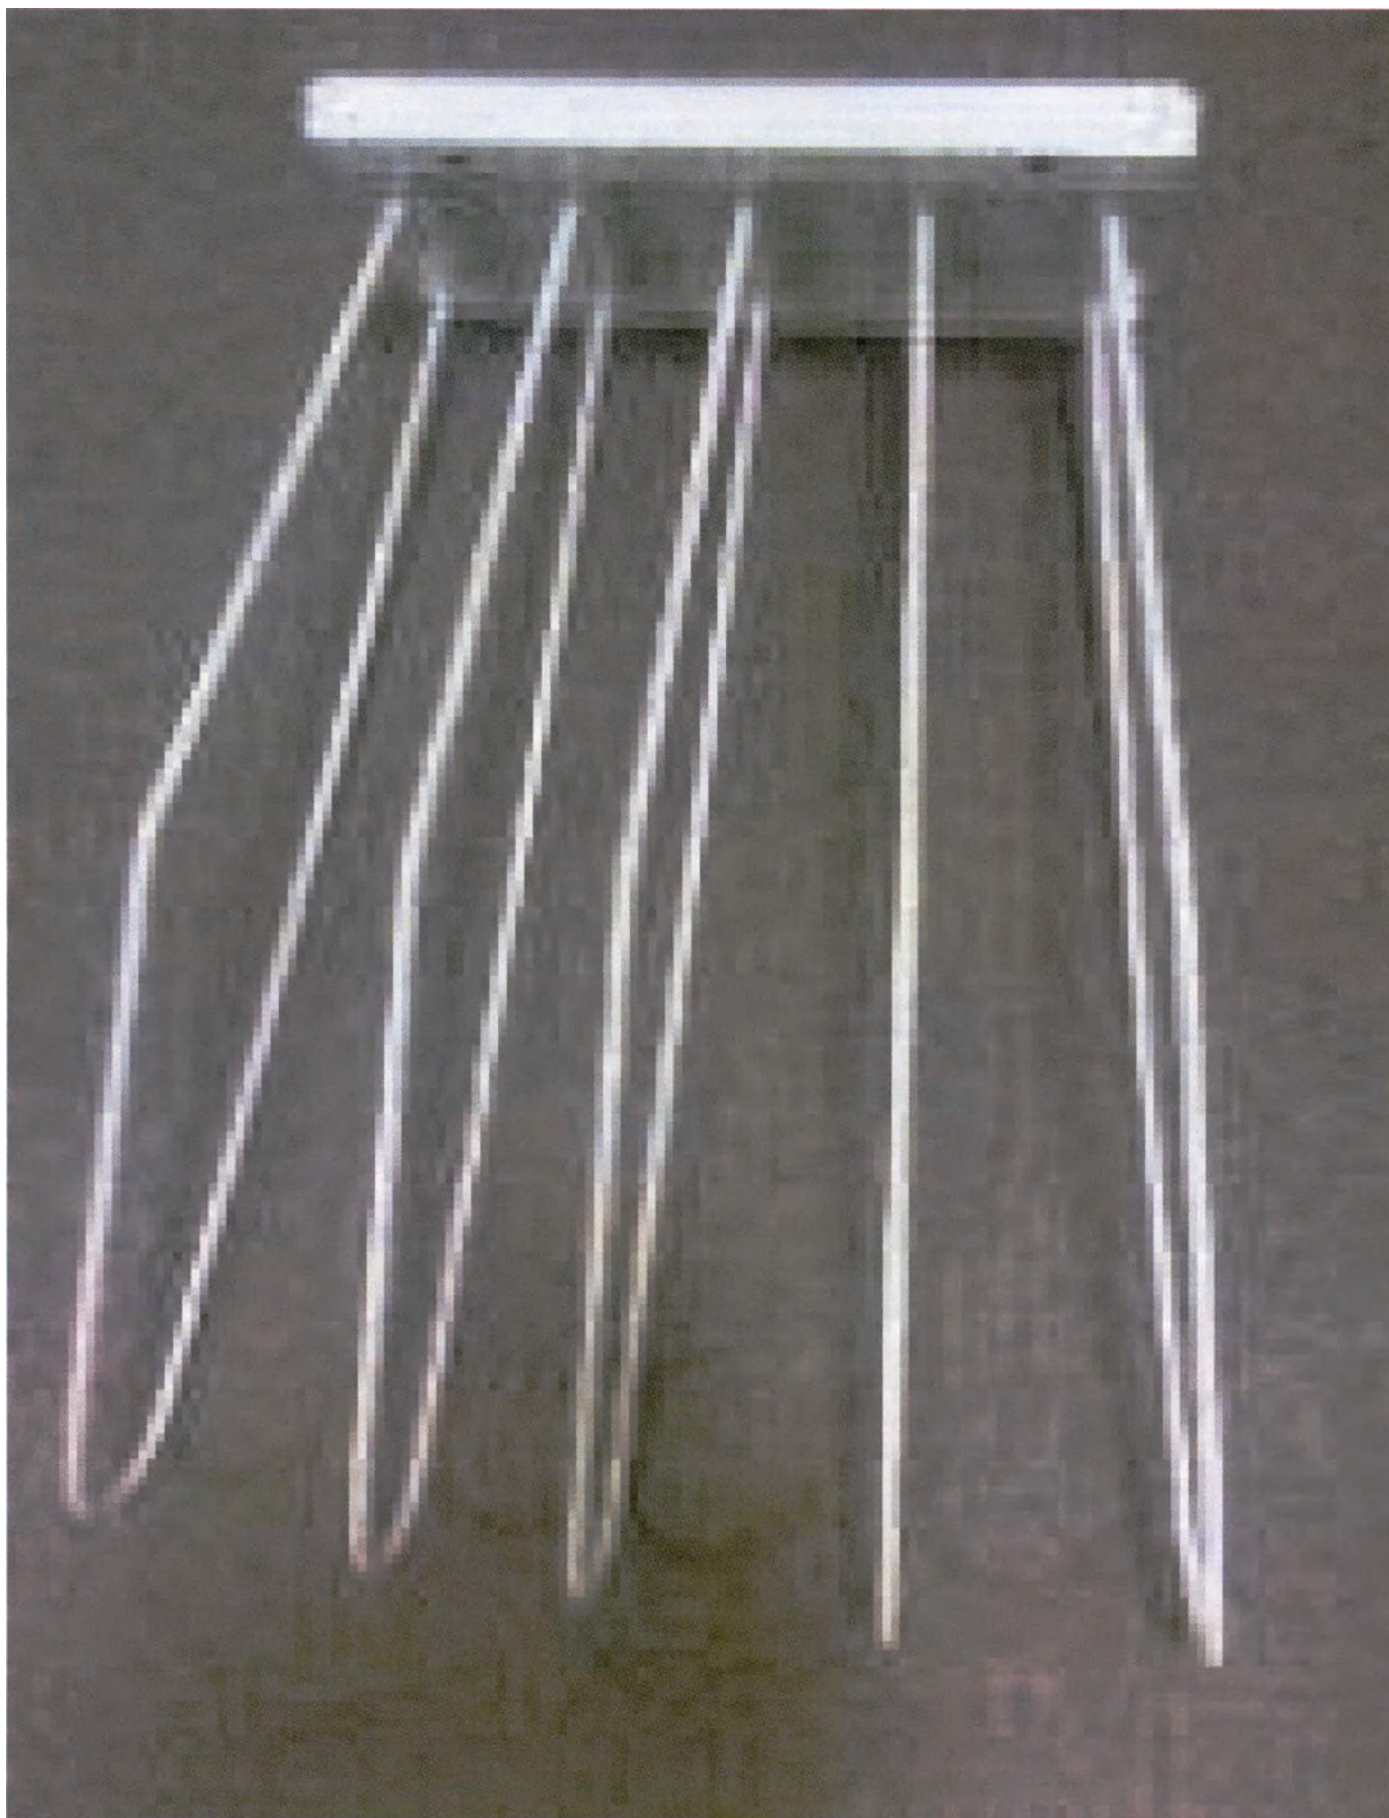


Рисунок 113. Настенные вешалки для рентгенозащитных средств



Рисунок 114. Робильная вешалка для рентгенозащитных средств



Рисунок 115. Кабели и крепления для монтажа рабочей станции сбора медицинских данных

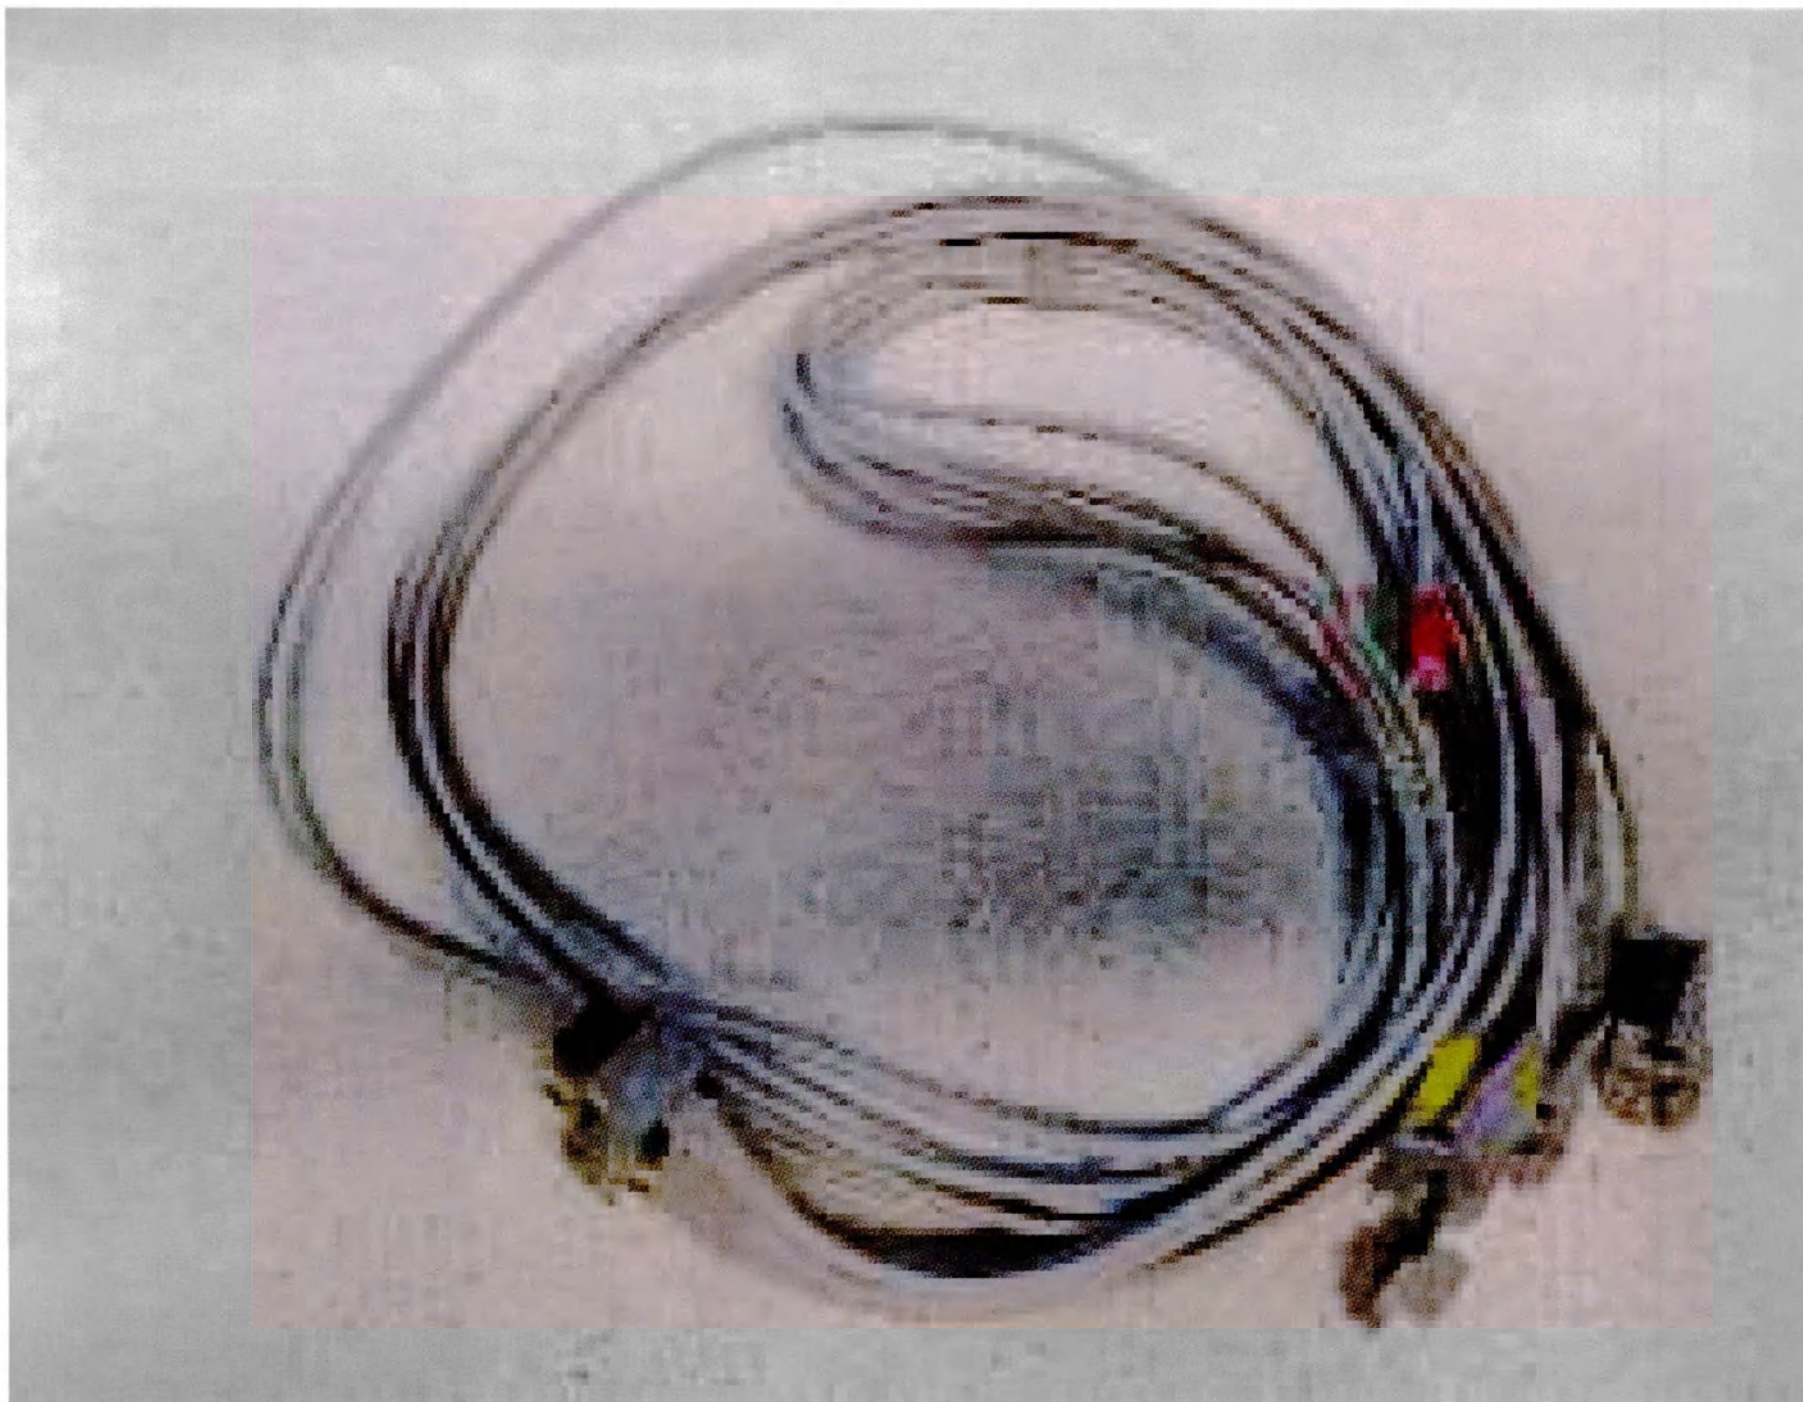


Рисунок 116. Кабели для сбора медицинских данных



Рисунок 117. Рабочая станция сбора медицинских данных



Рисунок 118. Модуль сбора медицинских данных

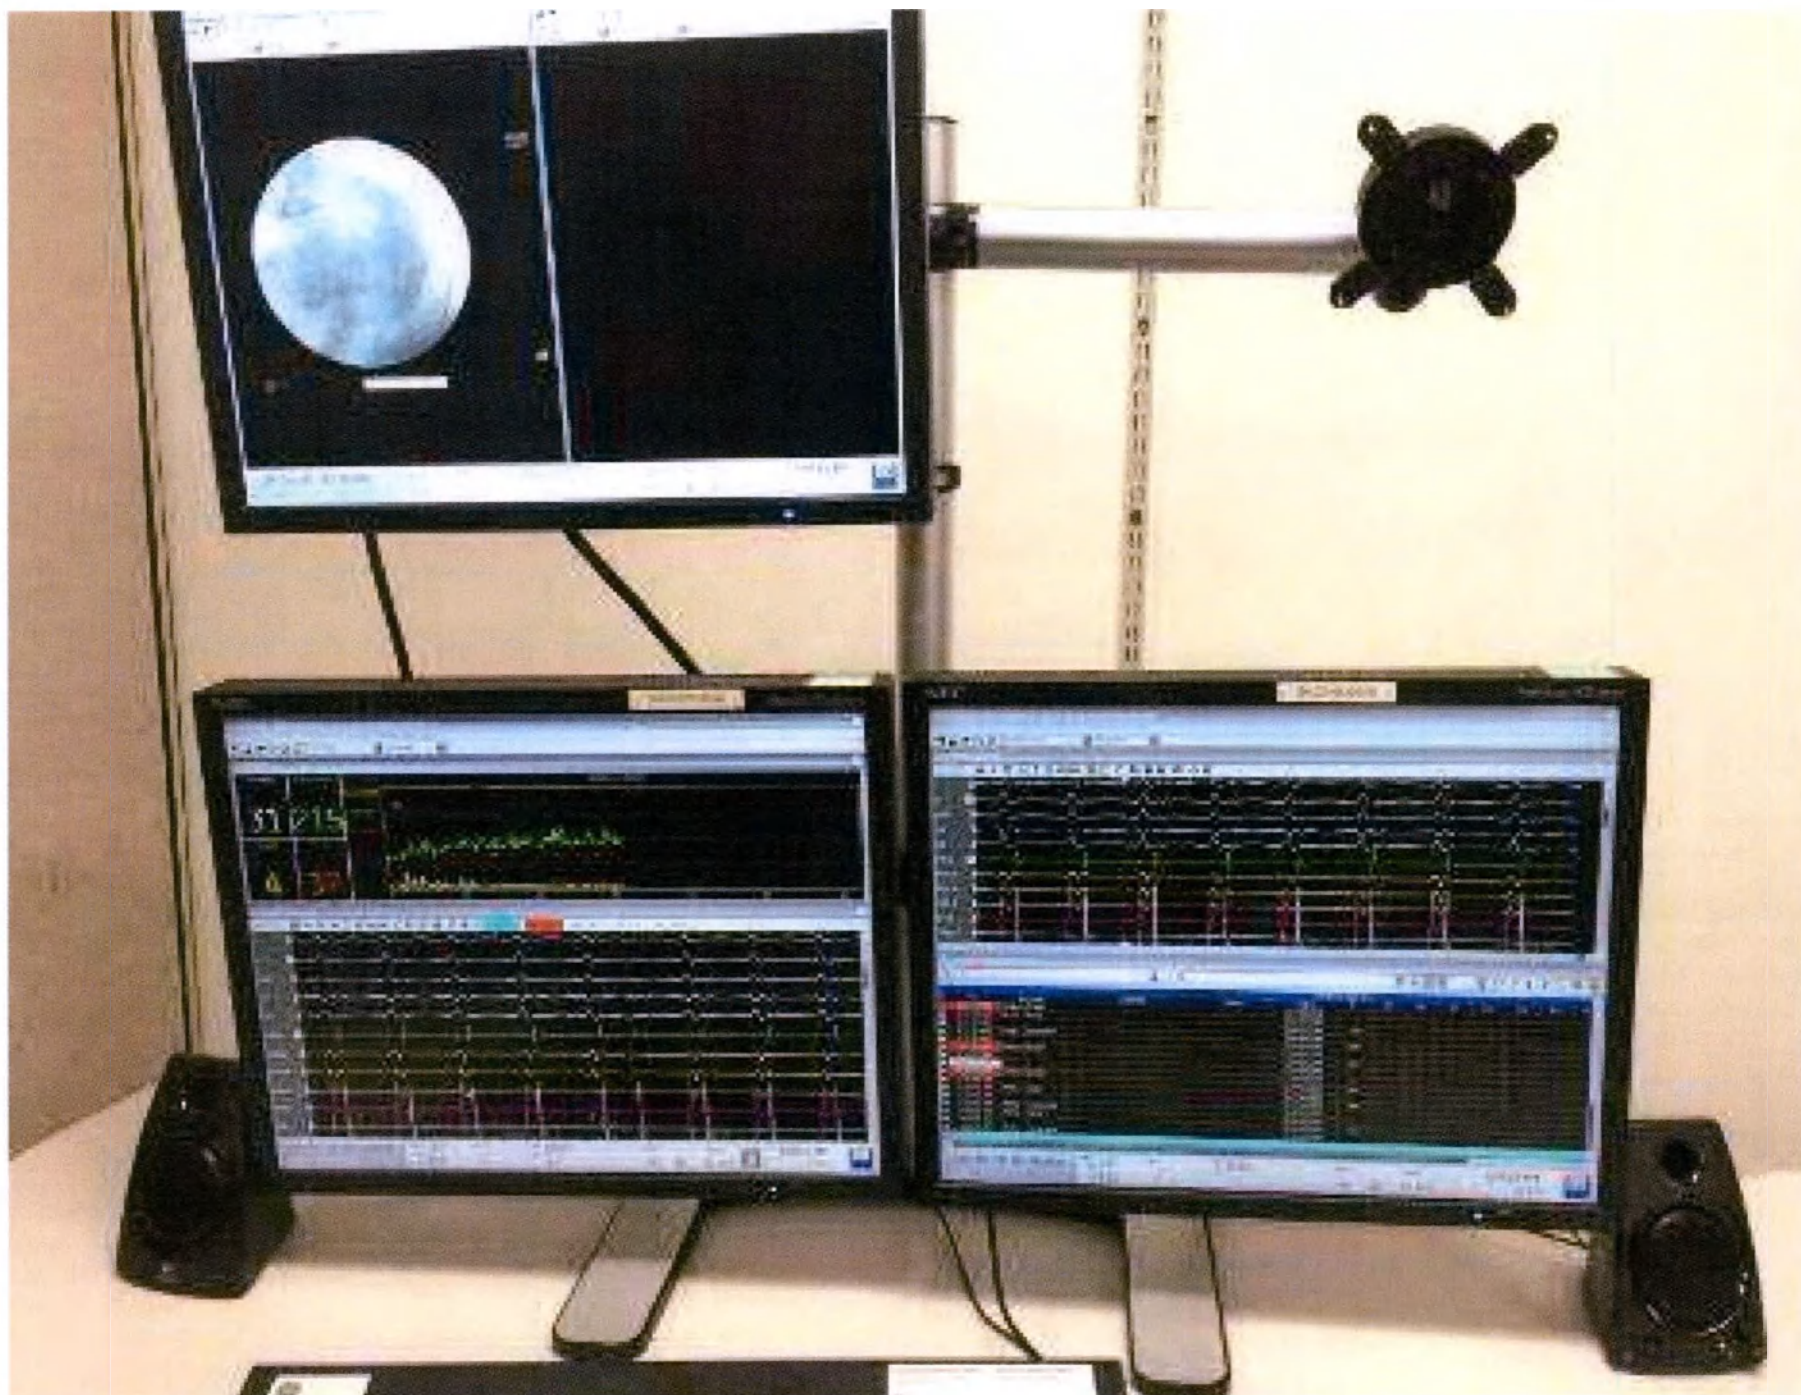


Рисунок 119. Мониторы станции сбора медицинских данных



Рисунок 120. Столы для пультовой для монтажа рабочей станции



Рисунок 121. Клавиатура системы рабочей станции



Рисунок 122. Периферийное оборудование для автоматизированных рабочих мест



Рисунок 123. Устройство бесперебойного питания для рабочей станции сбора медицинских данных



Рисунок 124. Переговорное устройство для рабочей станции сбора медицинских данных



Рисунок 125. Усилитель электрофизиологических сигналов



Рисунок 126. Кардиостимулятор

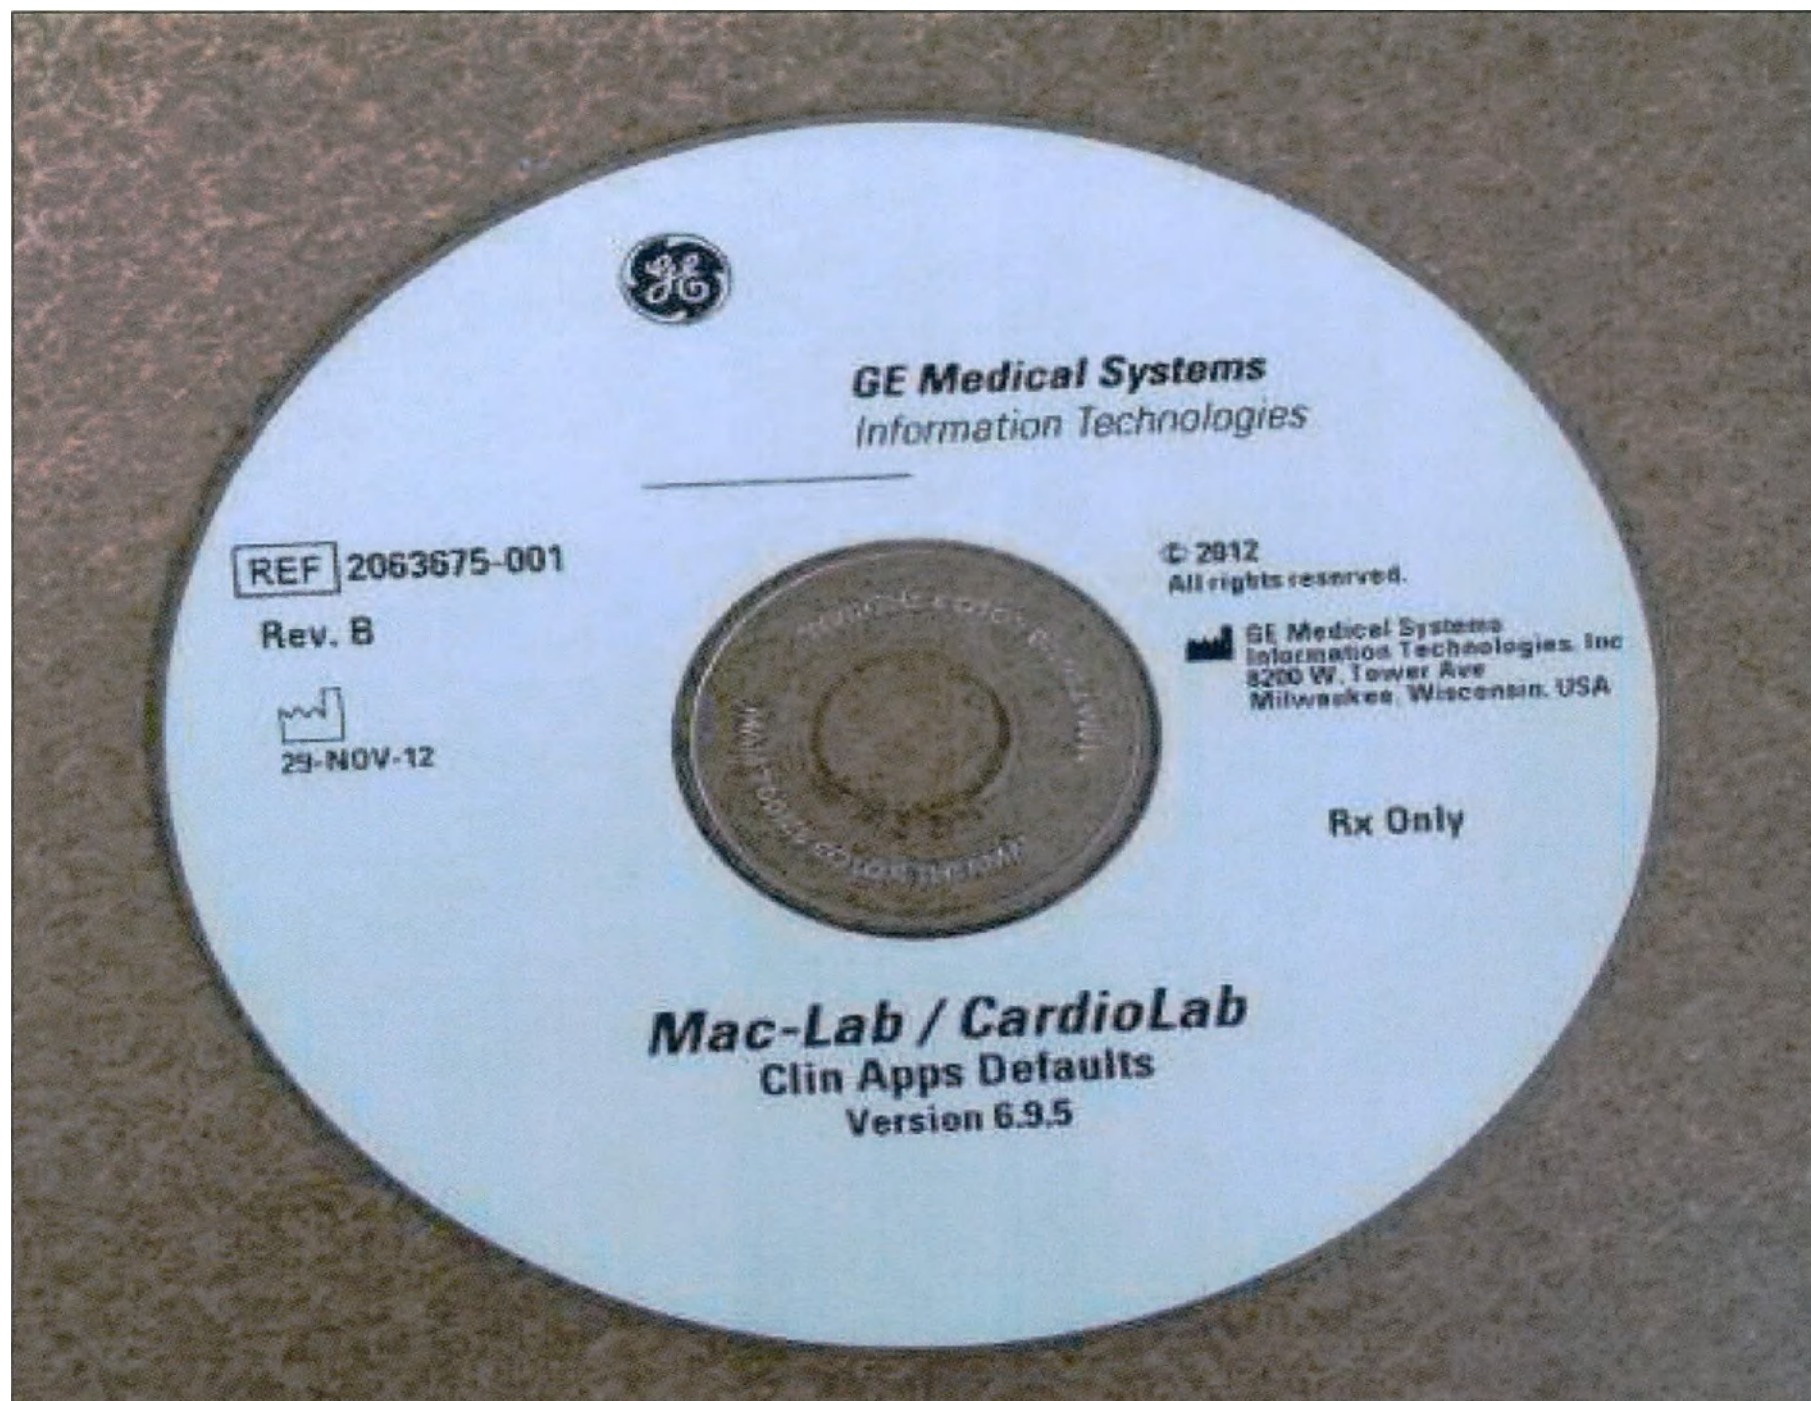


Рисунок 127. Программное обеспечение для анализа данных на оптическом или электронном носителе

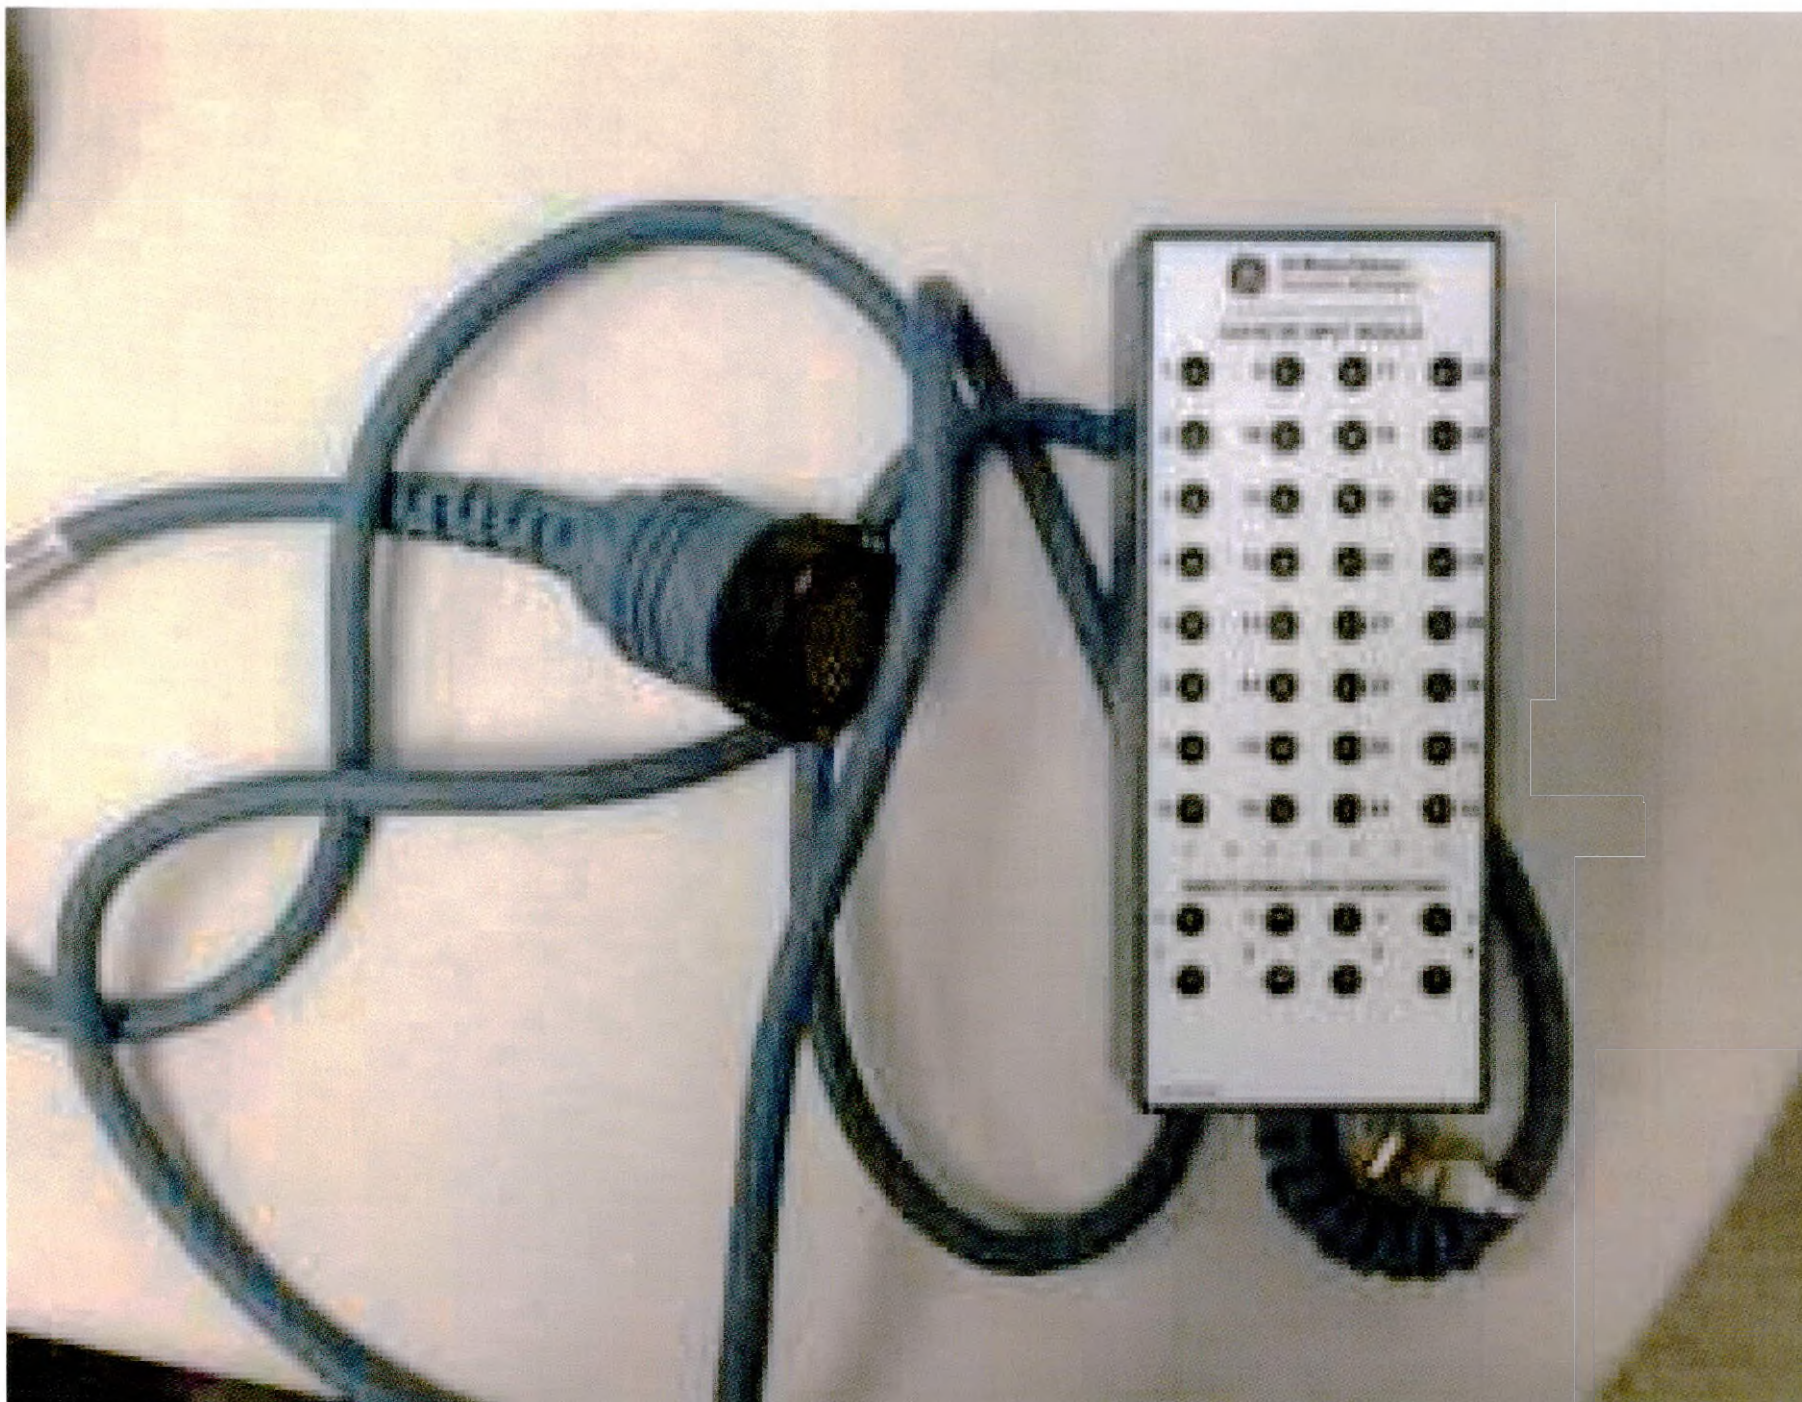


Рисунок 128. Кабели для усилителя электрофизиологических сигналов



Рисунок 129. Блок интегральных схем



Рисунок 130. Шнуры питания рабочей станции сбора медицинских данных



Рисунок 131. Кабели и датчики для регистрации физиологических данных



Рисунок 132. Датчики инвазивного давления

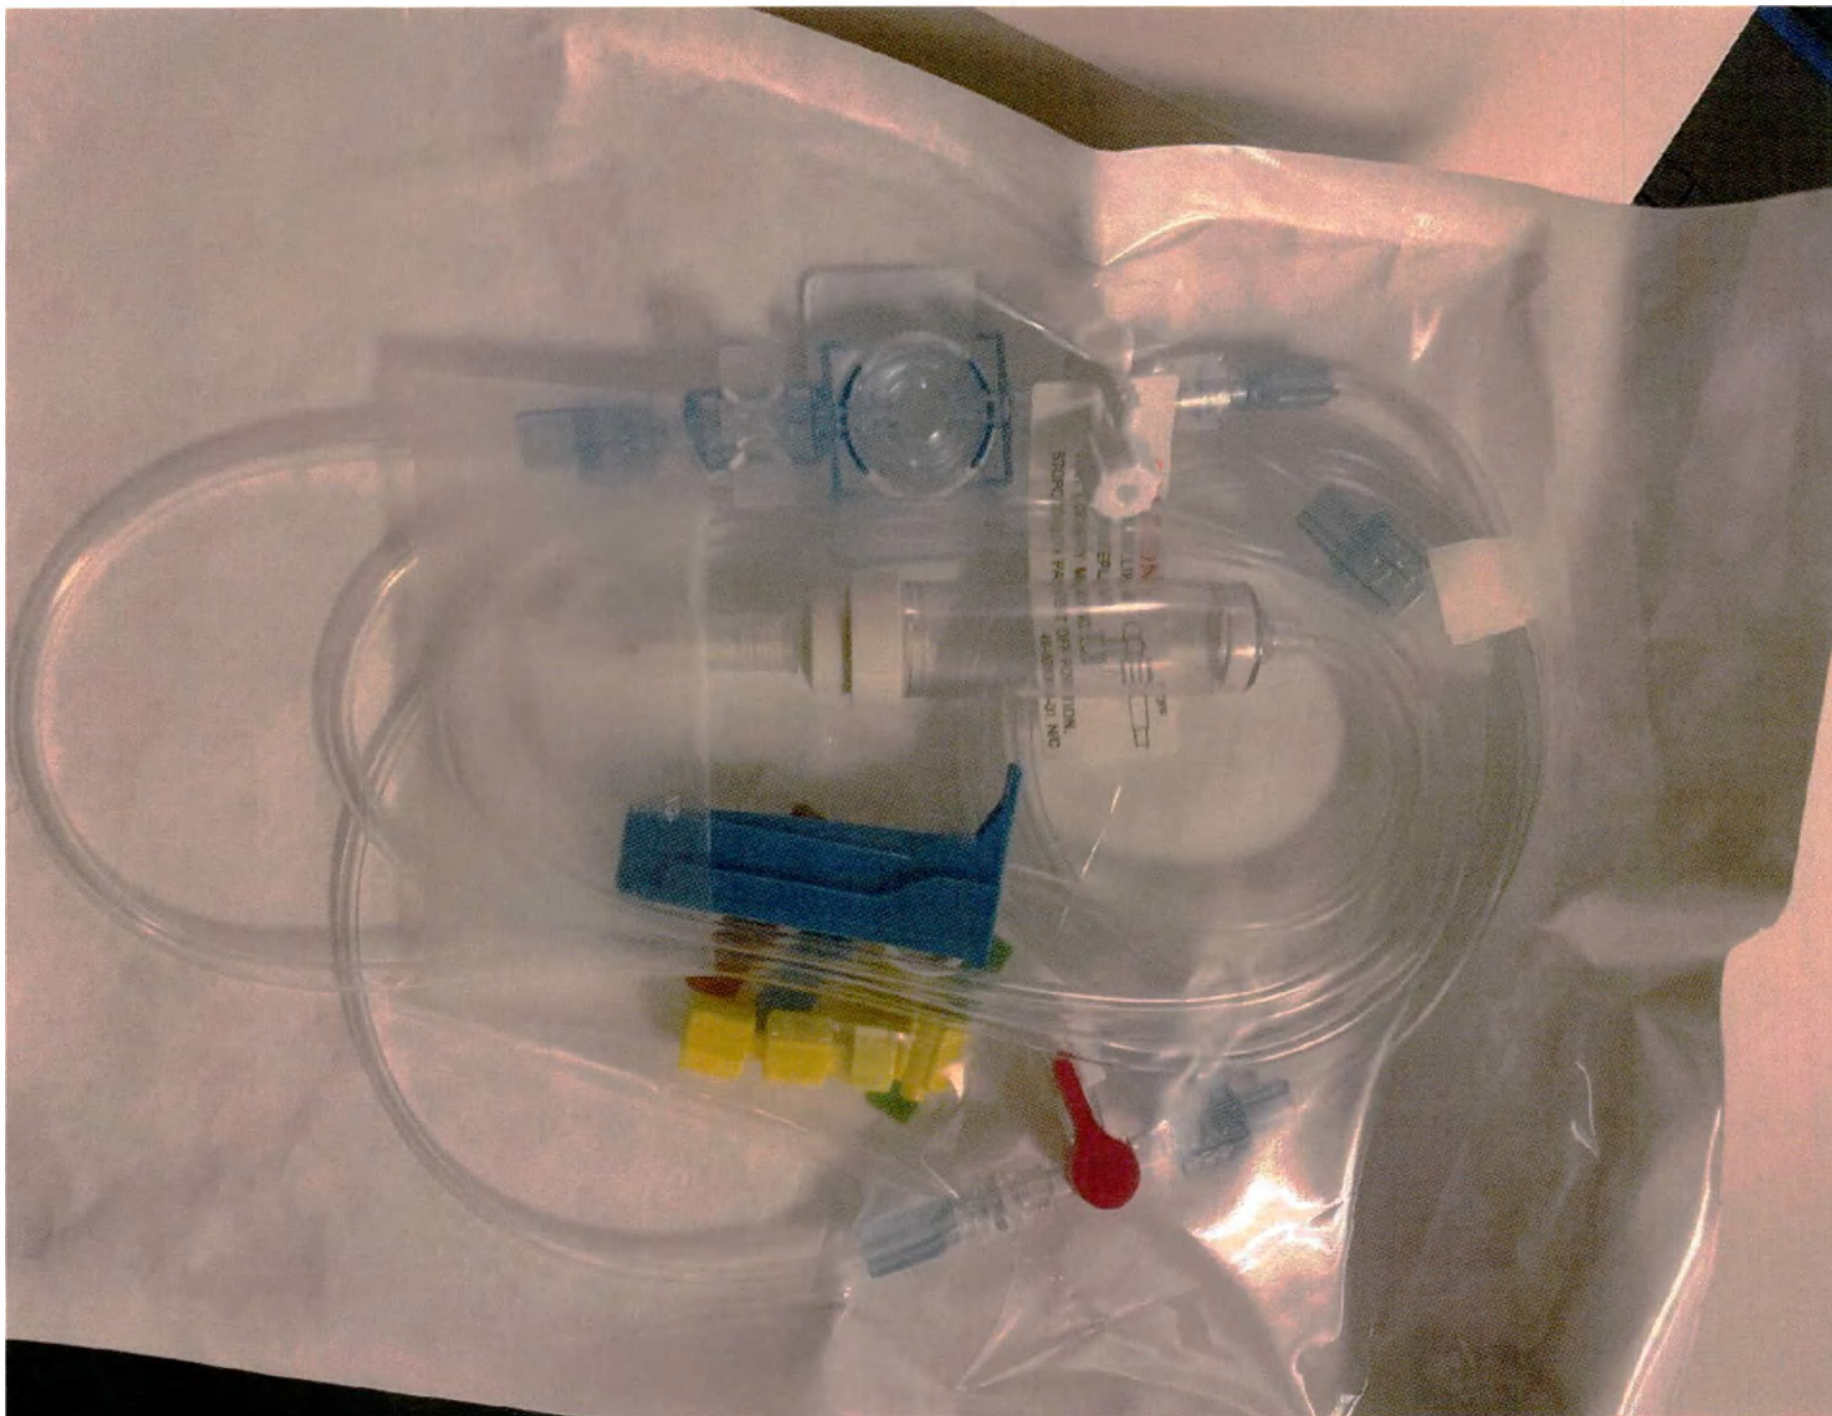


Рисунок 133. Одноразовые линии датчика инвазивного давления



Рисунок 134. Корпус монитора пациента



Рисунок 135. Аккумулятор монитора пациента



Рисунок 136. Программное обеспечение монитора пациента основное



Рисунок 137. Программное обеспечение монитора пациента для анестезиологии



Рисунок 138. Программное обеспечение монитора пациента для интенсивной терапии



Рисунок 139. Программное обеспечение для неотложной медицины



Рисунок 140. Базовый комплект ключей программного обеспечения монитора пациента для анестезиологии



Рисунок 141. Ключ для активации опции лицензионного программного обеспечения «измерение анестетика» монитора пациента на бумажном или оптическом носителе.



Рисунок 142. Ключ программного обеспечения «Доступ к данным информационной кардиологической системы» монитора пациента



Рисунок 143. Ключ программного обеспечения «Тренды 72 часа» монитора пациента



Рисунок 144. ключ программного обеспечения «Тренды высокого разрешения» монитора пациента



Рисунок 146. Ключ программного обеспечения «Единовременный анализ ЭКГ в 12 отведениях и диагностика ишемии миокарда» монитора пациента



Рисунок 147. Ключ для активации опции лицензионного программного обеспечения «AIPN – просмотр данных IPANEL»

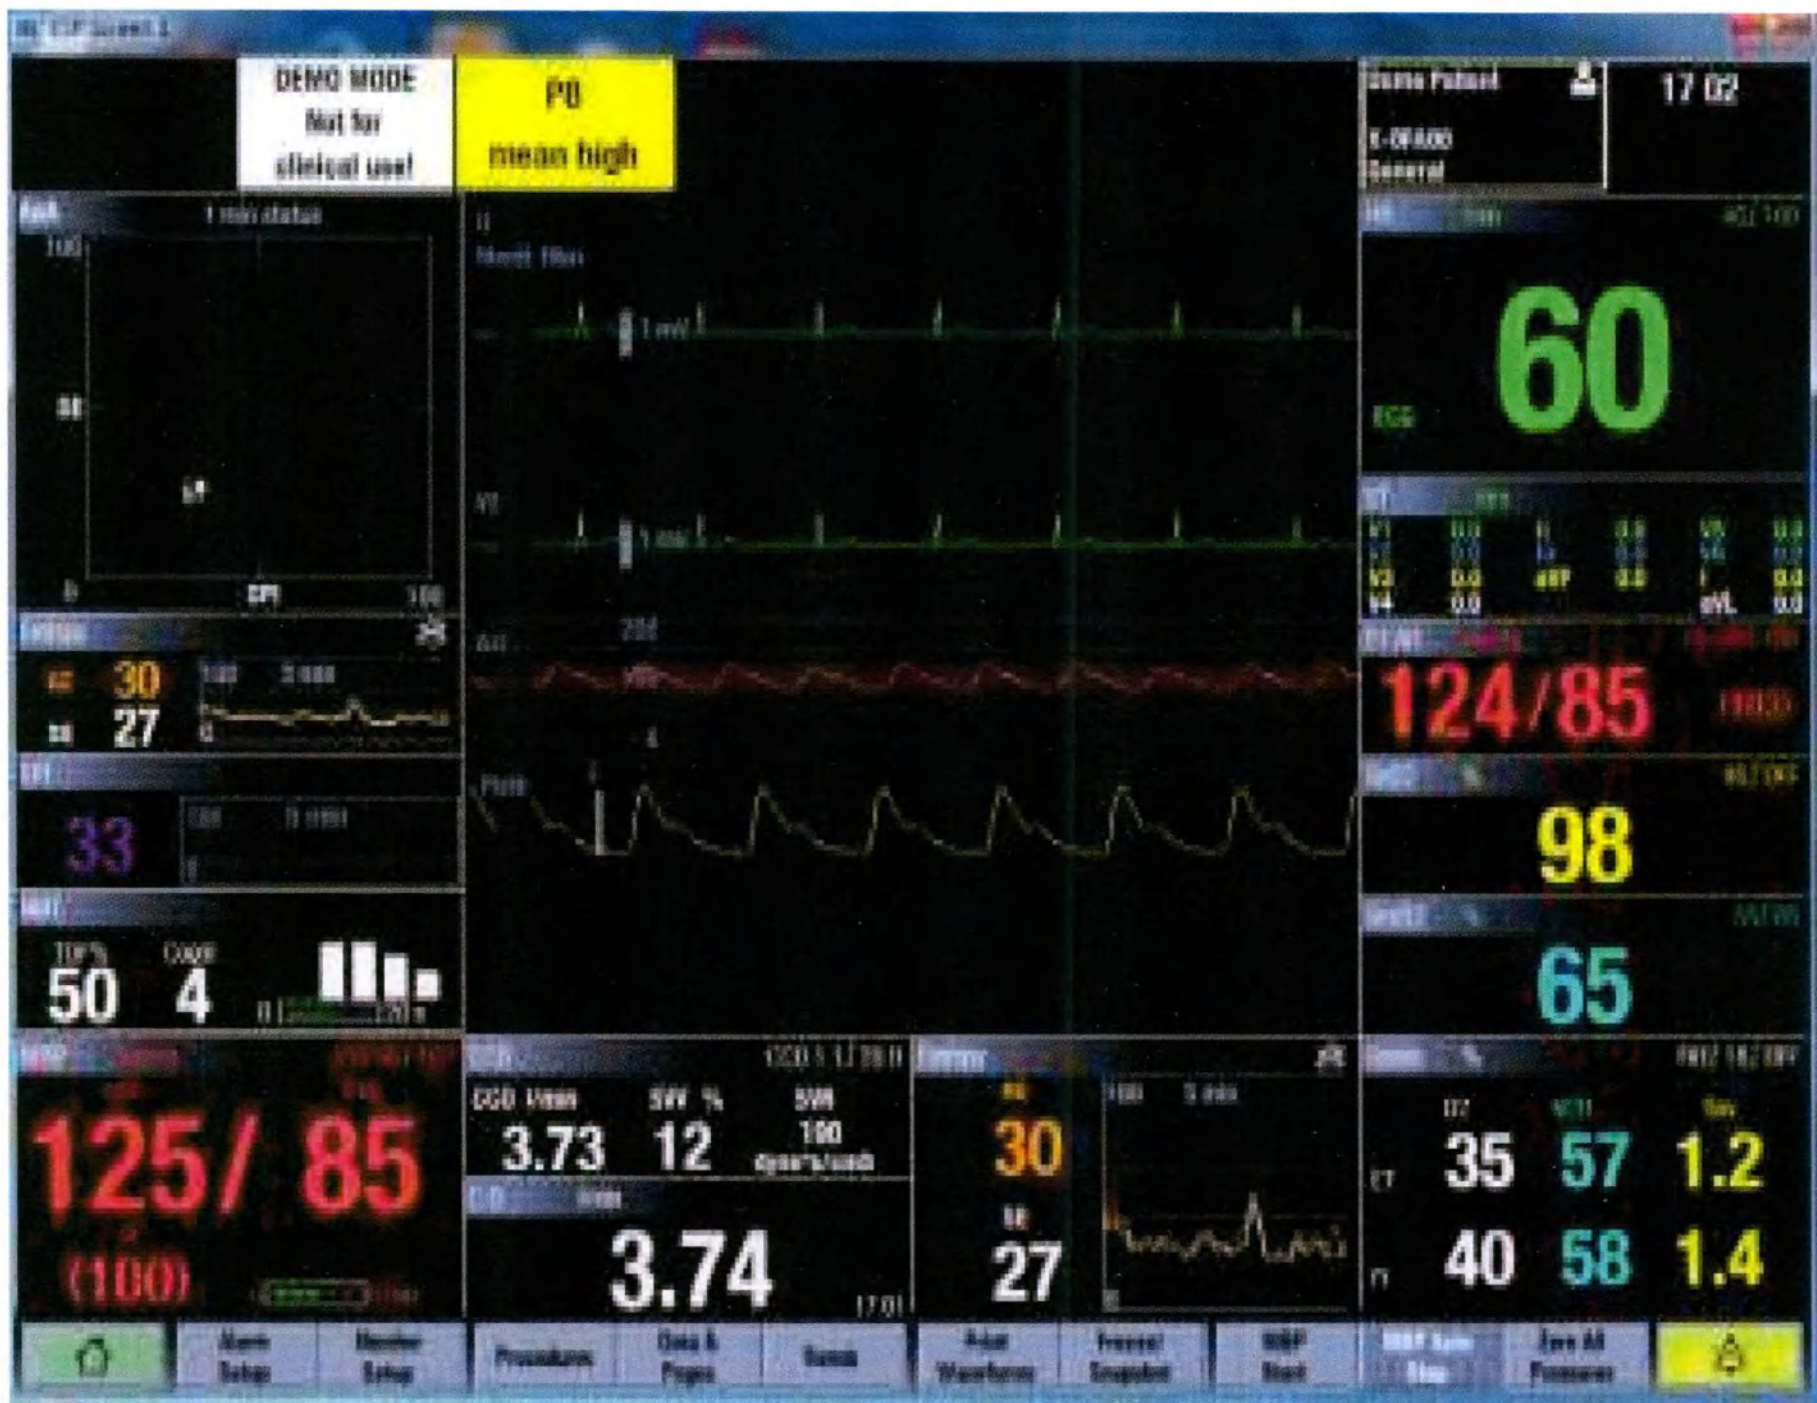


Рисунок 148. Ключ программного обеспечения для просмотра гистограмм монитора пациента



Рисунок 149. Ключ программного обеспечения «Измерение сердечного выброса методом PICCO» монитора пациента



Рисунок 150. Ключ для активации опции лицензионного программного обеспечения «Измерение SvO2» монитора пациента на бумажном или оптическом носителе



Рисунок 151. Ключ для активации опции лицензионного программного обеспечения «Аналгезия SPI» монитора пациента на бумажном или оптическом носителе



Рисунок 152. Ключ для активации опции лицензионного программного обеспечения «Двойное видео» монитора пациента на бумажном или оптическом носителе



Рисунок 153. Приложение программное iPanel монитора пациента



Рисунок 154. Ключ для активации опции лицензионного программного обеспечения «Расчет сердечного выброса» монитора пациента на бумажном или оптическом носителе



Рисунок 155. Ключ для активации опции лицензионного программного обеспечения «Гемодинамические расчеты» монитора пациента на бумажном или оптическом носителе



Рисунок 156. Ключ для активации опции лицензионного программного обеспечения «Полный анализ аритмий» монитора пациента на бумажном или оптическом носителе.



Рисунок 157. Ключ для активации опции лицензионного программного обеспечения «Muse View» монитора пациента на бумажном или оптическом носителе



Рисунок 158. Ключ для активации опции лицензионного программного обеспечения «72-часовой анализ трендов» монитора пациента на бумажном или оптическом носителе



Рисунок 159. Ключ для активации опции лицензионного программного обеспечения «Тренды высокого разрешения» монитора пациента на бумажном или оптическом носителе.

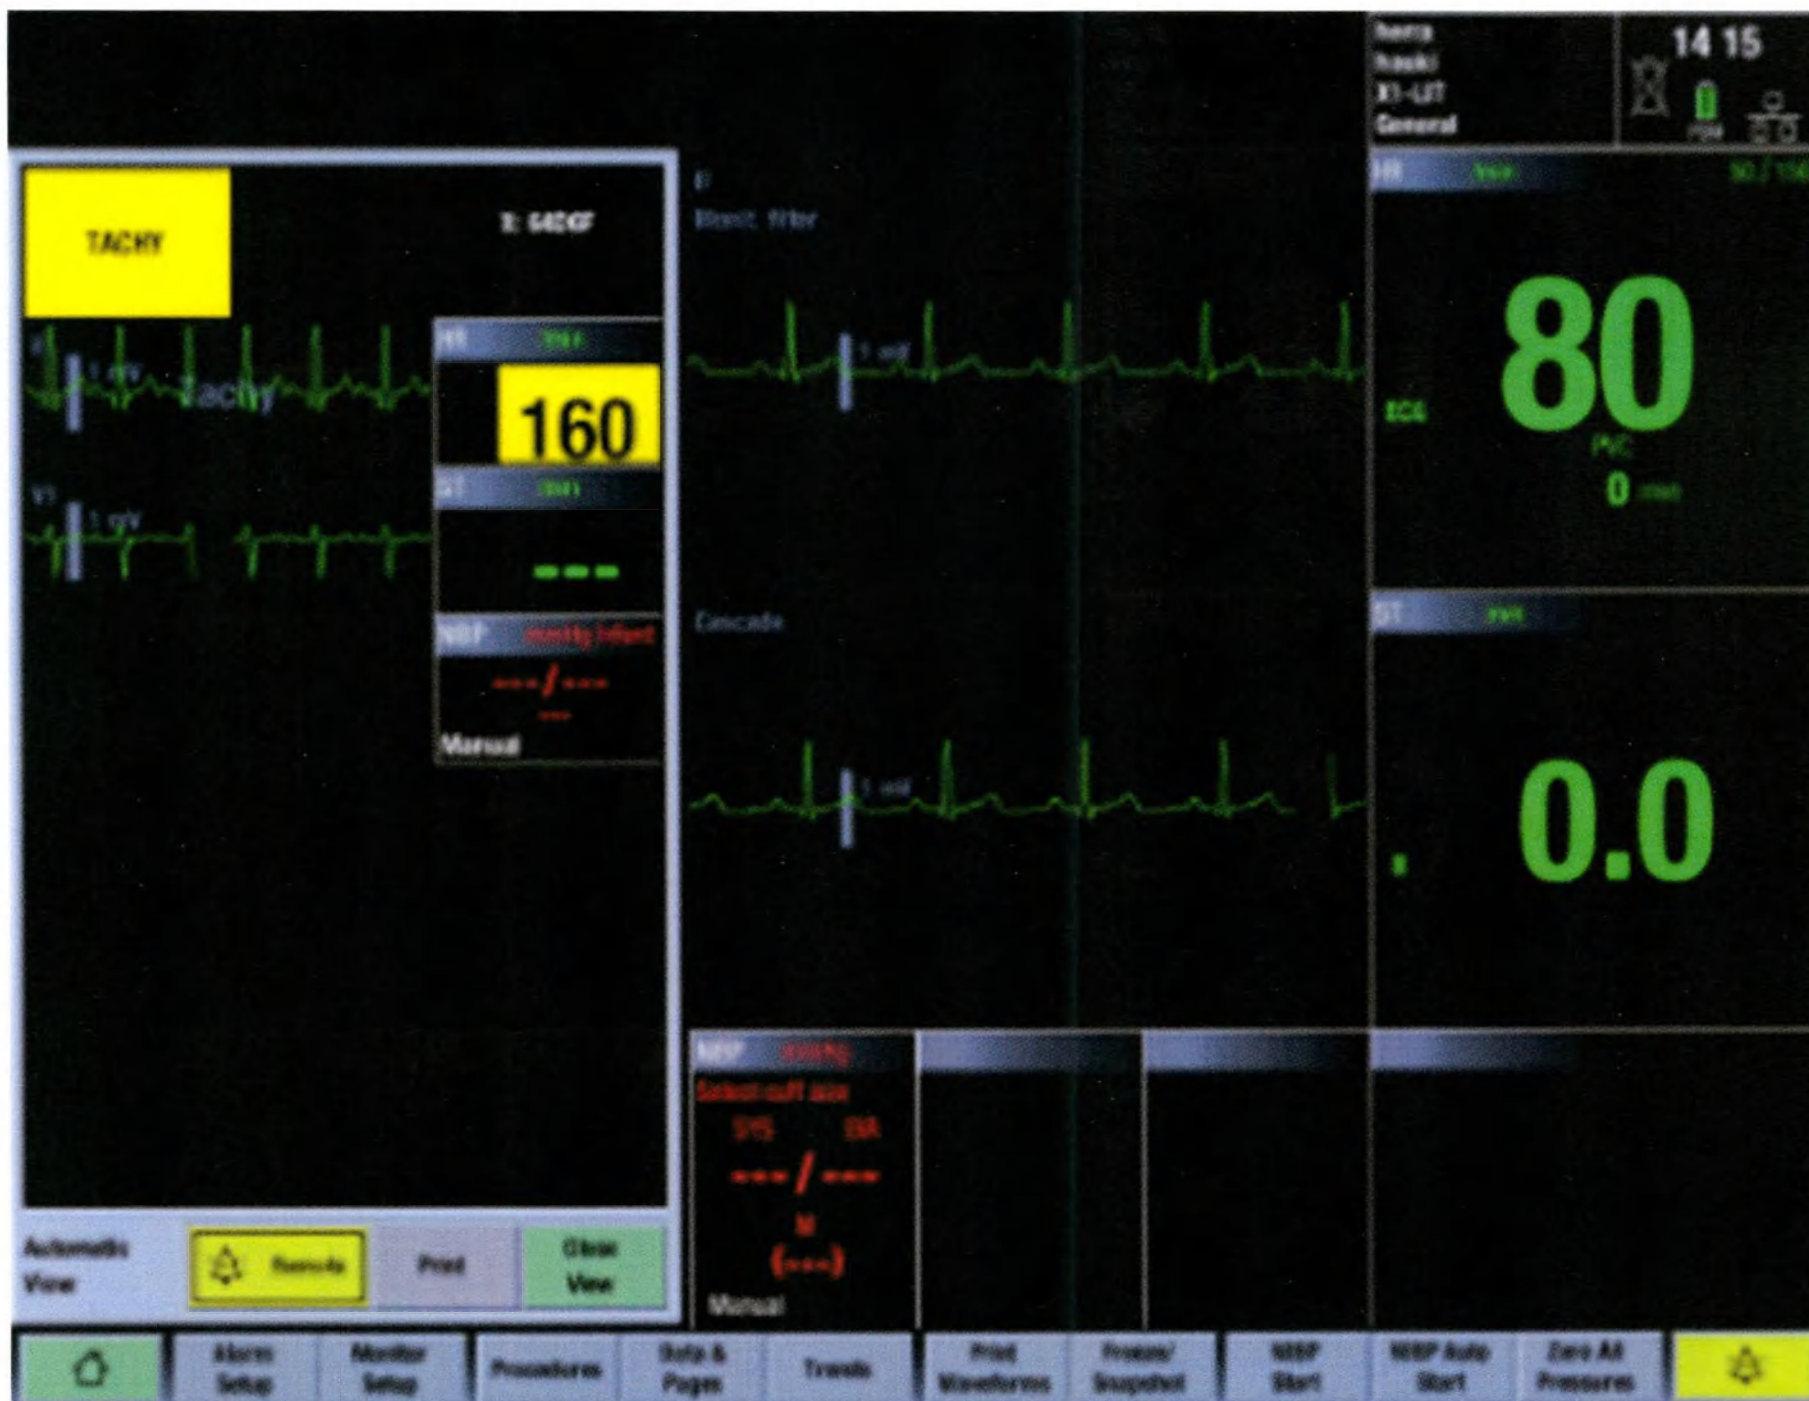


Рисунок 160. Ключ для активации опции лицензионного программного обеспечения «Сеть и автоматический просмотр тревог» монитора пациента на бумажном или оптическом носителе



Рисунок 161. Ключ для активации опции лицензионного программного обеспечения «ЭКГ 12SL с ACI-TPI» монитора пациента на бумажном или оптическом носителе



Рисунок 162. Ключ для активации опции лицензионного программного обеспечения «ЭКГ 12RL с 12 отведениями» монитора пациента на бумажном или оптическом носителе



Рисунок 163. Ключ для активации опции лицензионного программного обеспечения «Анализ ST с несколькими отведениями» монитора пациента на бумажном или оптическом носителе



Рисунок 164. Ключ для активации опции лицензионного программного обеспечения «Комбинированная ЭКГ телеметрия» монитора пациента на бумажном или оптическом носителе



Рисунок 165. Кабель питания монитора для пациента



Рисунок 166. Модуль PDM монитора для пациента

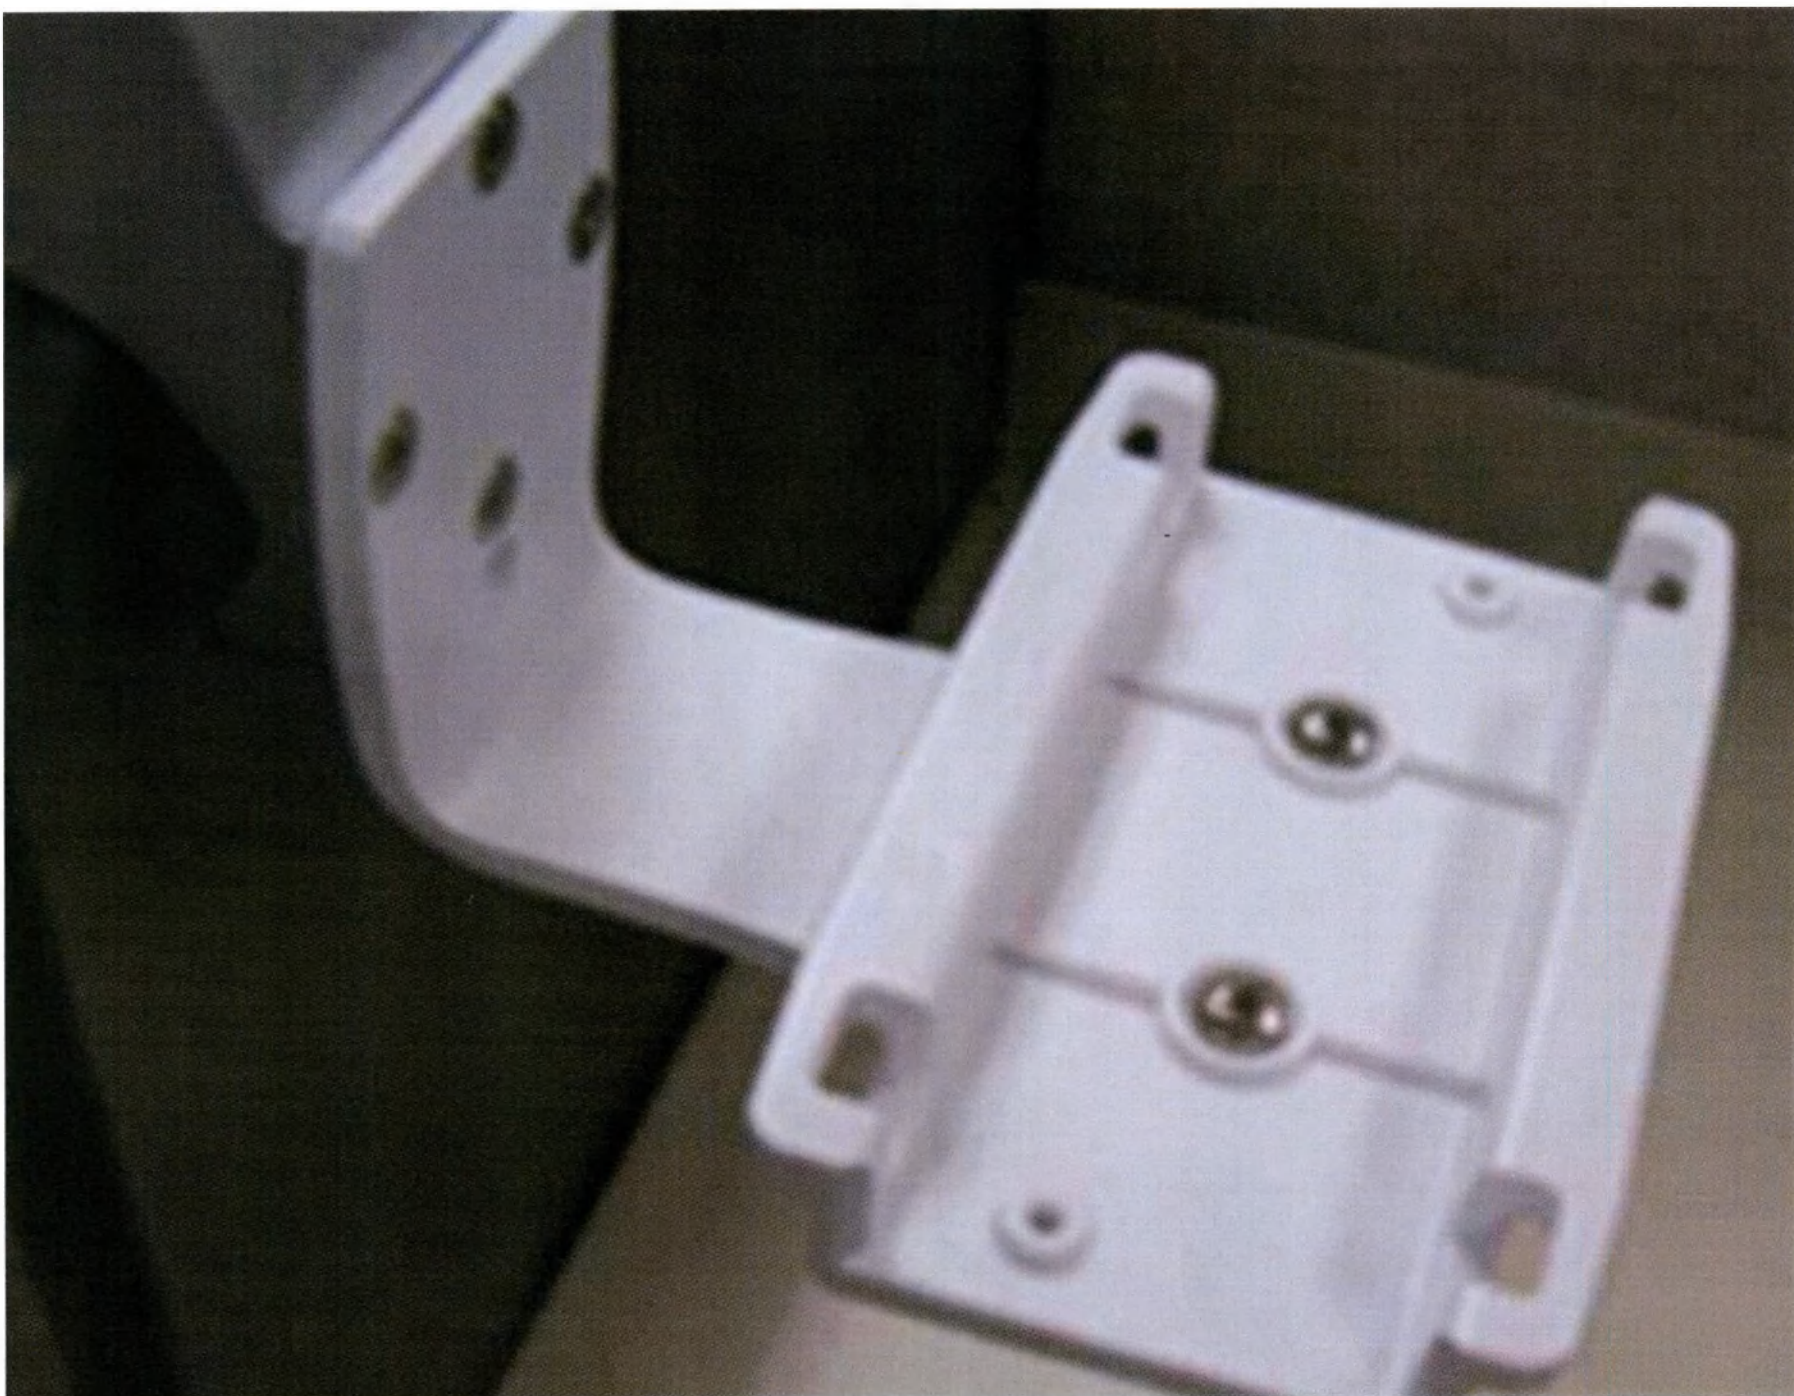


Рисунок 167. Mini-Dock модуля PDM монитора для пациента



Рисунок 168. Кабель подключения дистанционного управления монитора для пациента



Рисунок 169. Адаптер для плоской панели монитора для пациента

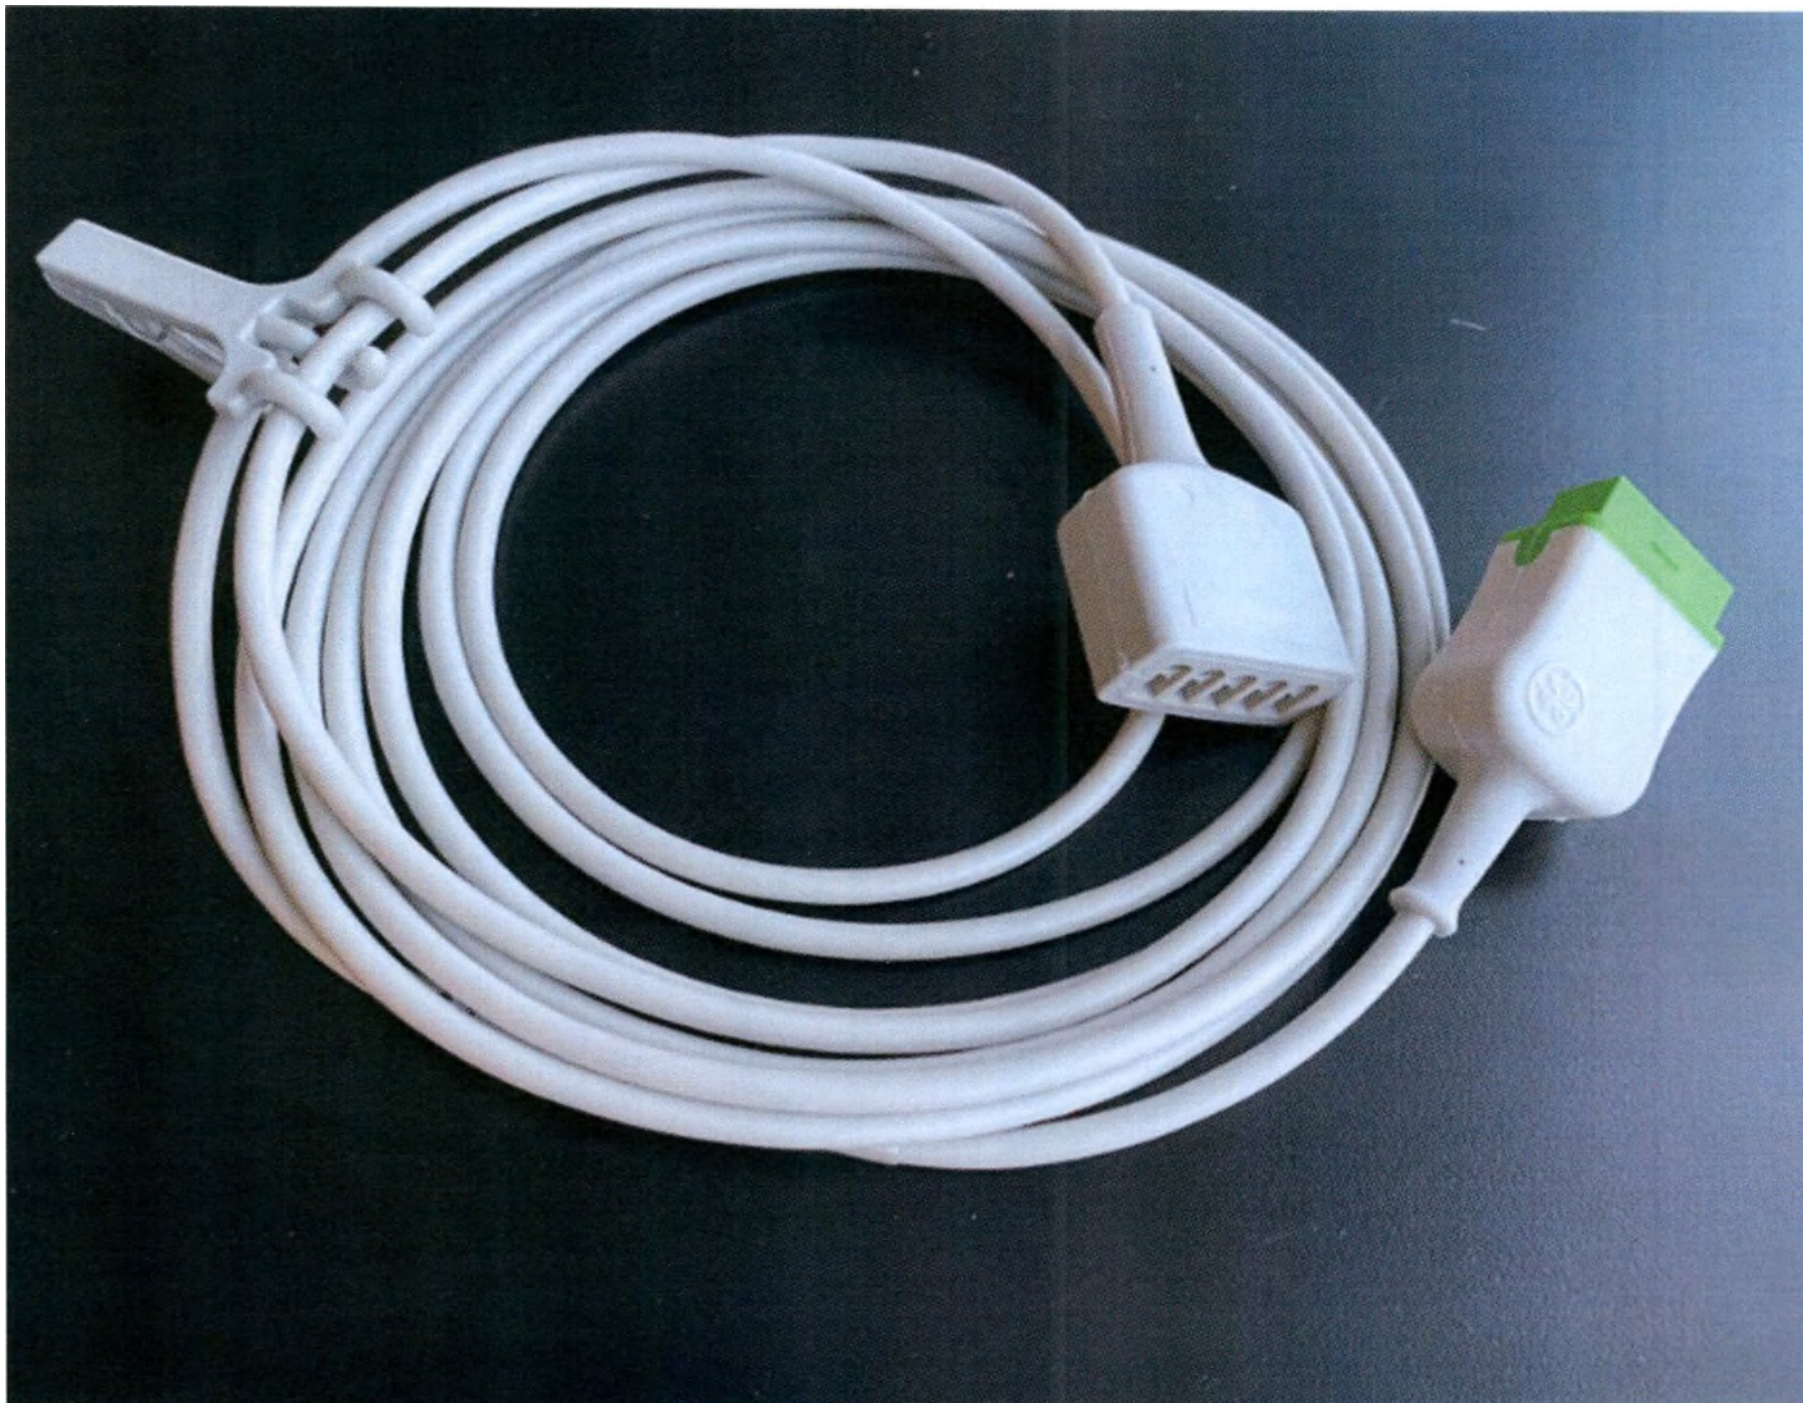


Рисунок 170. Кабель Multi-Link для ЭКГ на 3/5 отведений, IEC, 3,6 м монитора для пациента

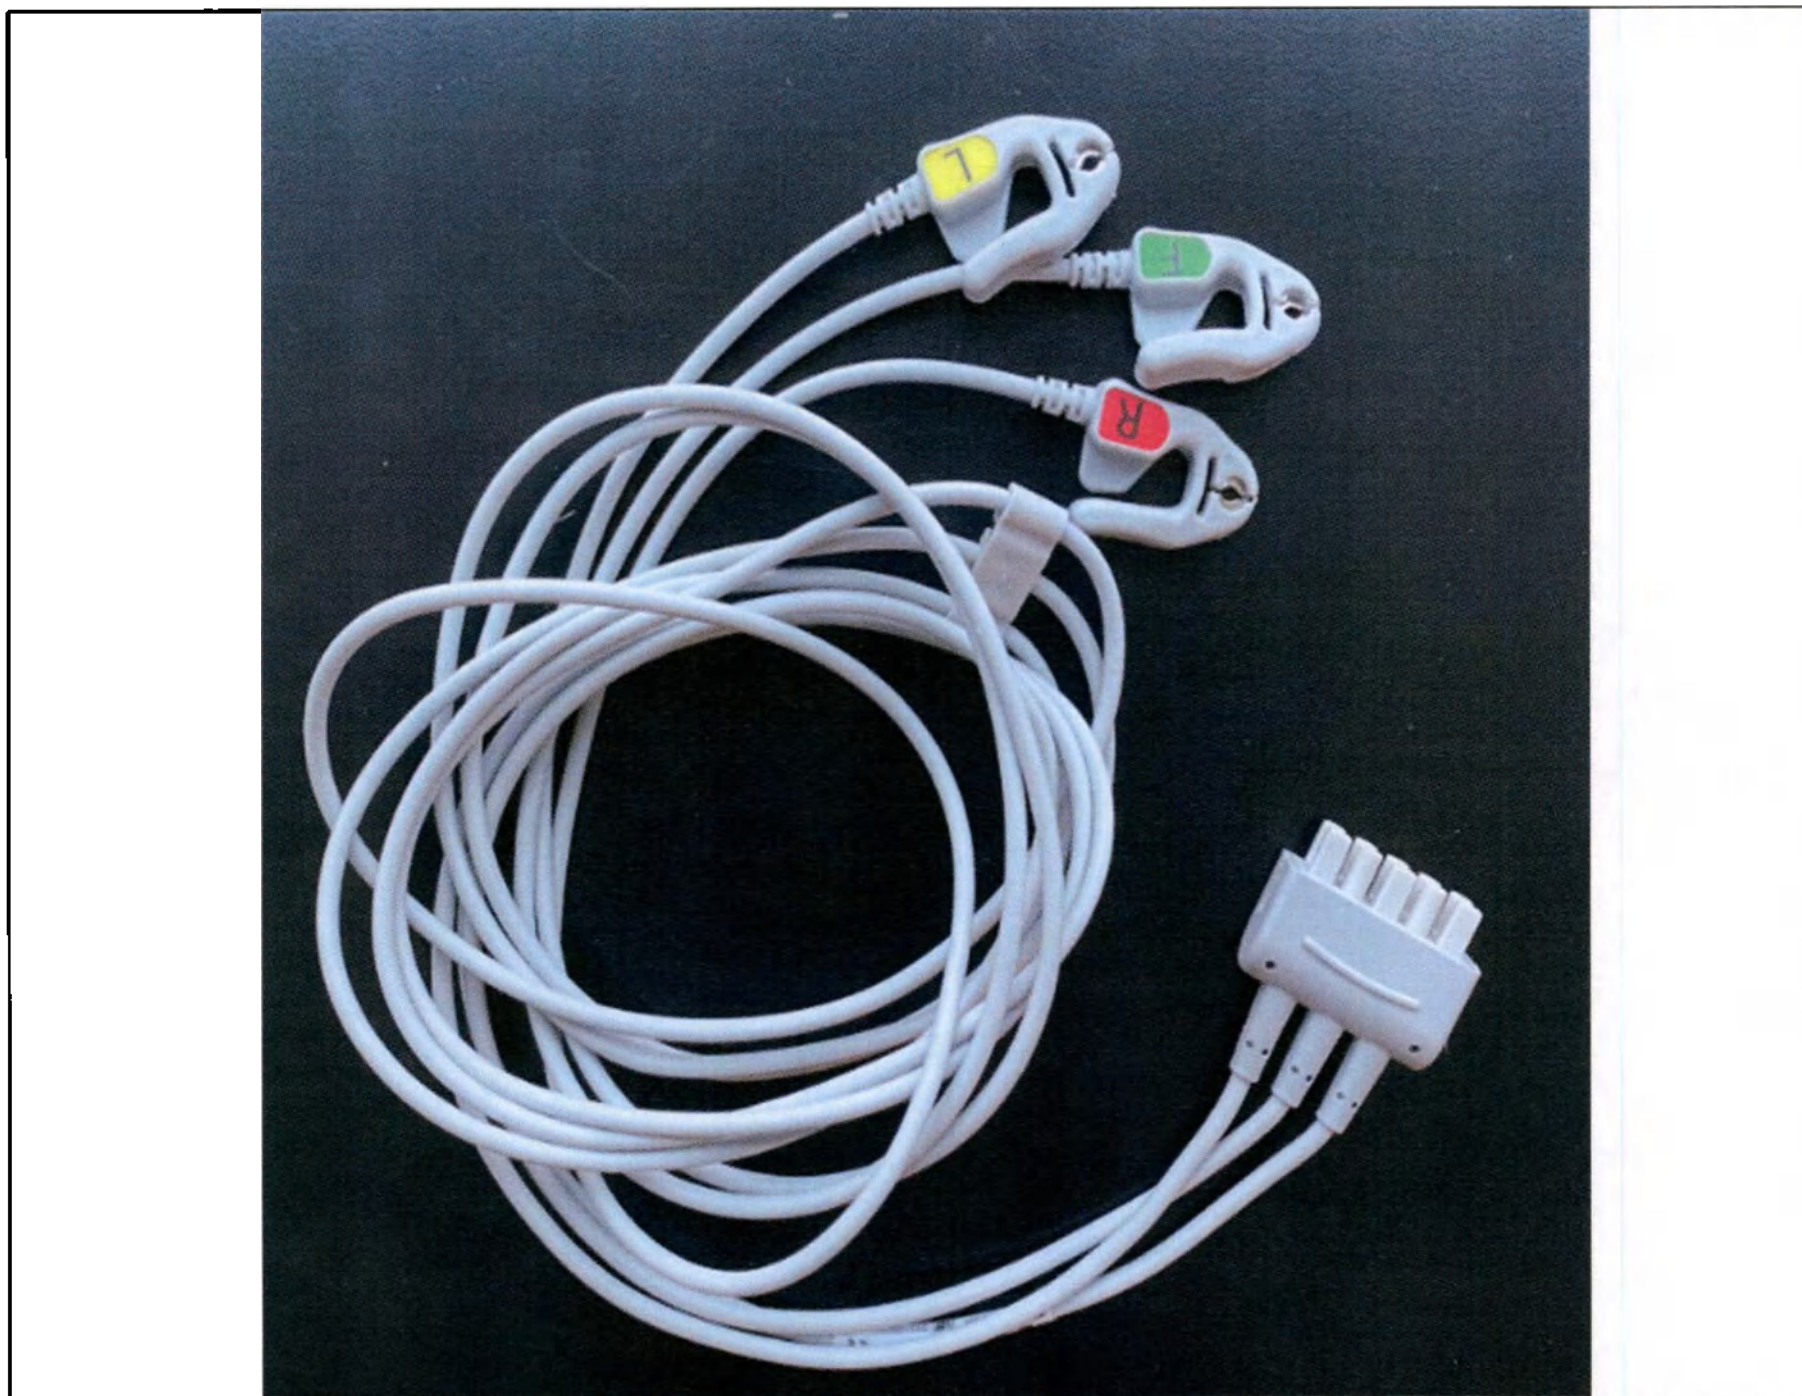


Рисунок 171. Провод контактный Multi-Link 3-канальный IEC. 130 см в комплекте с контактным устройством монитора для пациента



Рисунок 172. Провод контактный Multi-Link 5-канальный IEC, 130 см в комплекте с контактным устройством монитора для пациента



Рисунок 173. Кабель Multi-Link для ЭКГ на 12 отведений, ИЕС, 3,6 м монитора для пациента



2106391-003

Рисунок 174. Проводники отведений ЭКГ с незапресованными контактами, 5 отведений



Рисунок 175. Электроды ЭКГ SilverTRACE, взрослые, круглые



Рисунок 176. Соединительный кабель для Nellcor OxiMax, длина 3 м

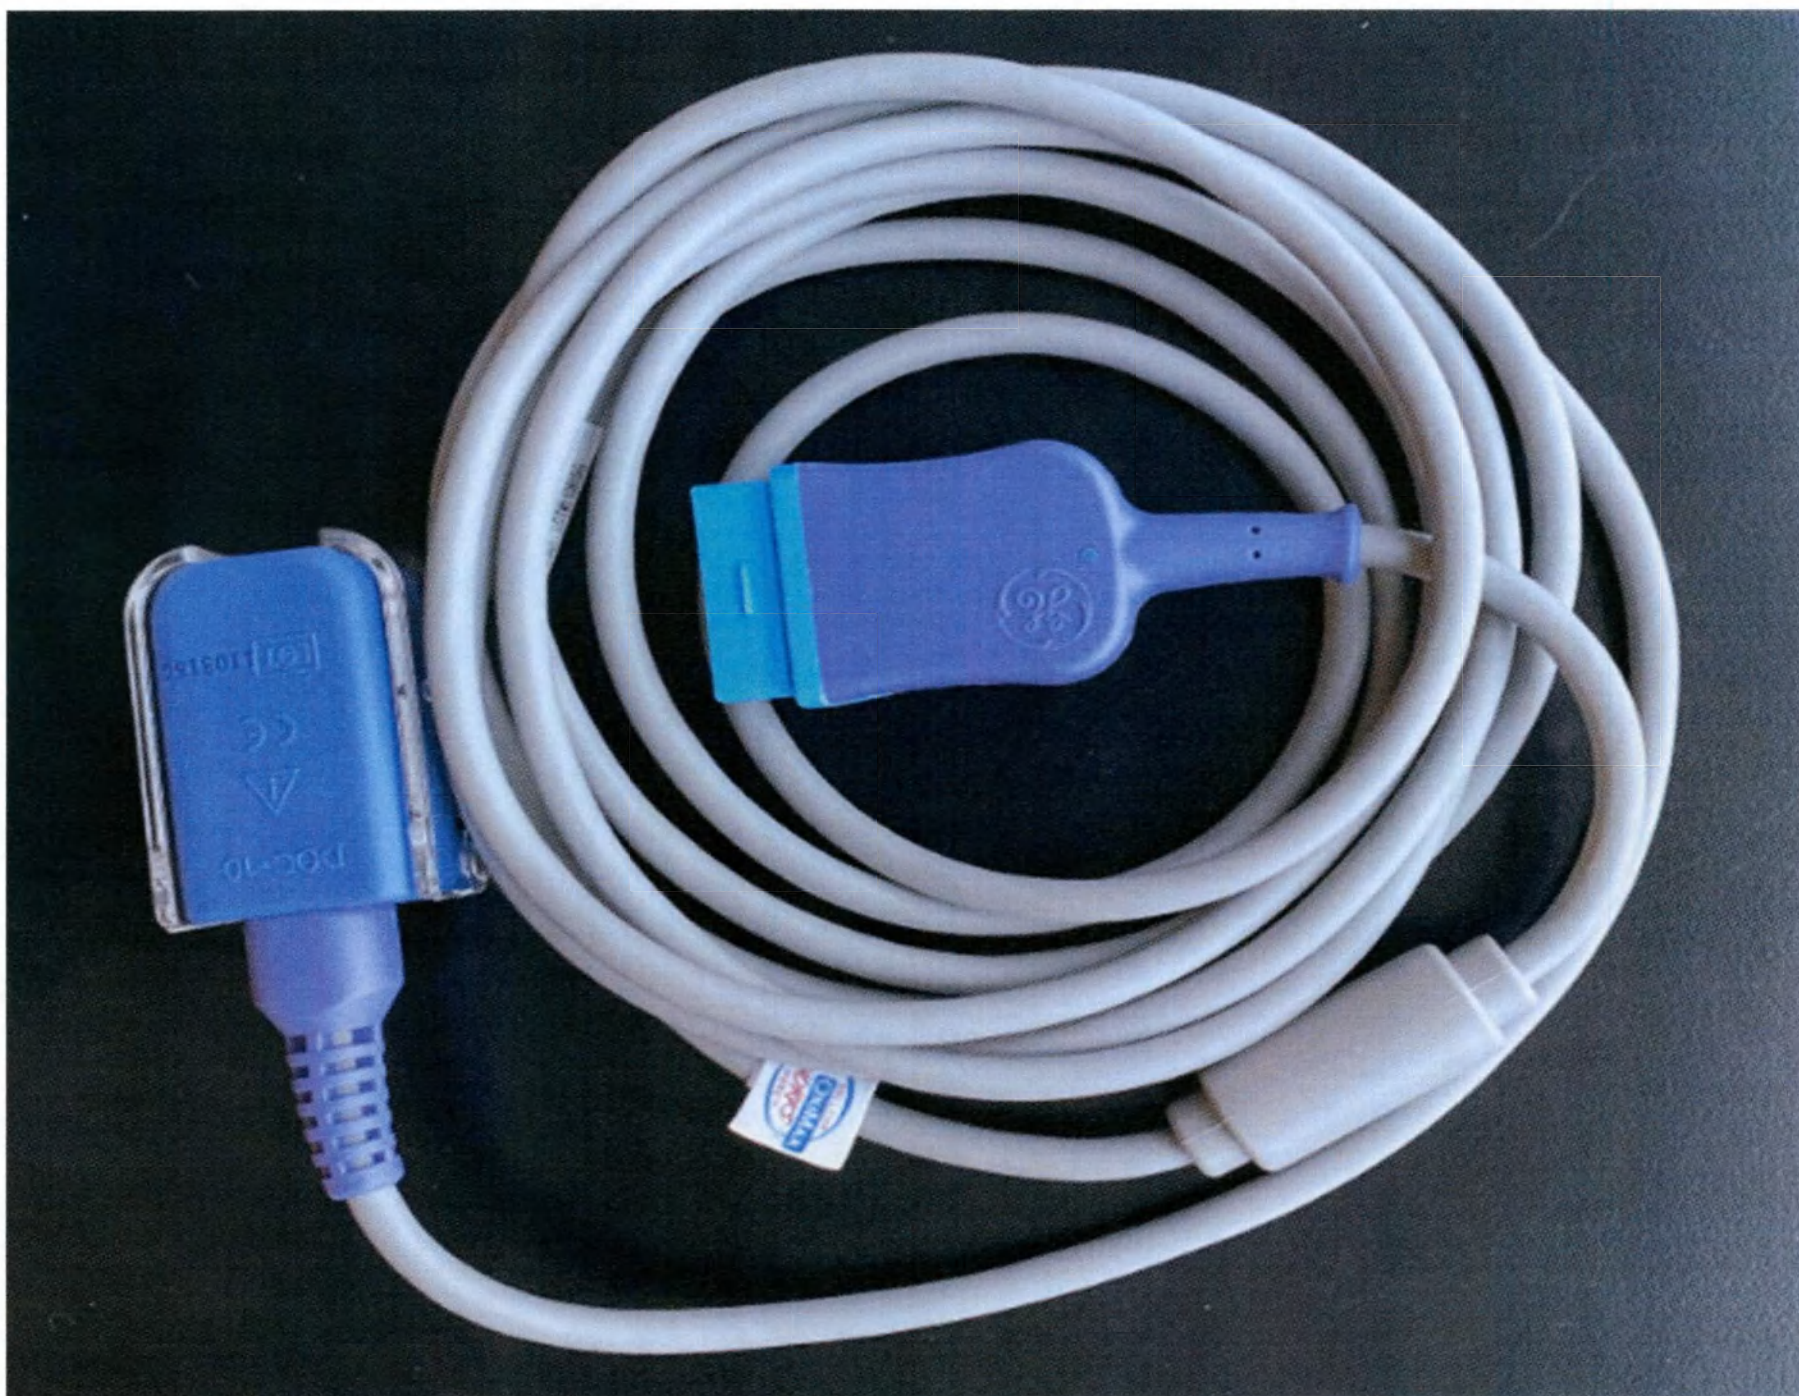


Рисунок 177. Датчик на палец, взрослый, DS100A



Рисунок 178. Воздушный шланг неинвазивного измерения давления



Рисунок 179. Манжета для взрослых

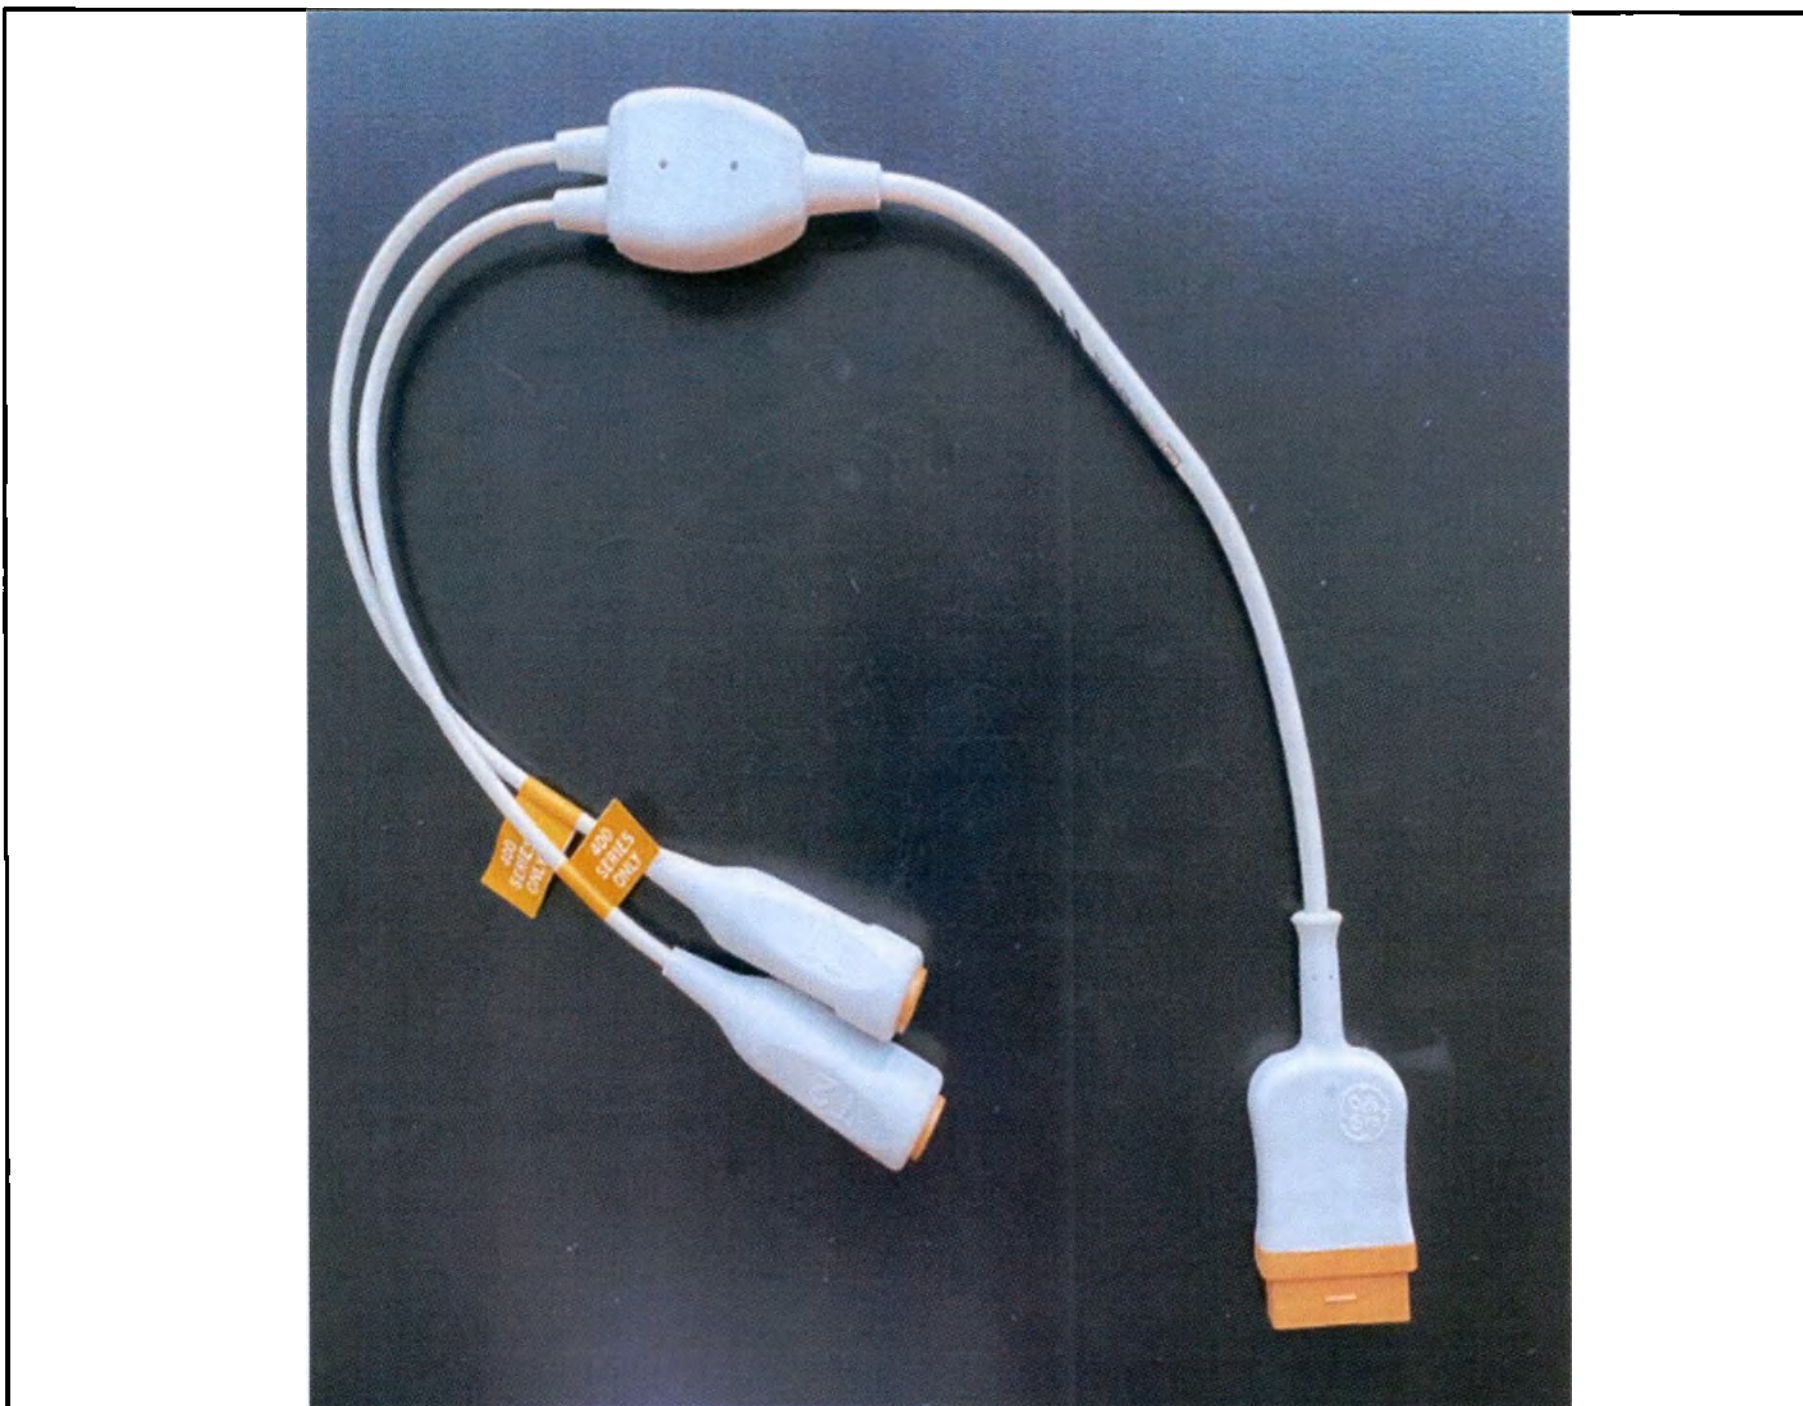


Рисунок 180. Двойной кабель датчика контроля температуры, 0,5 м, совместим с датчиками YSI серии 400

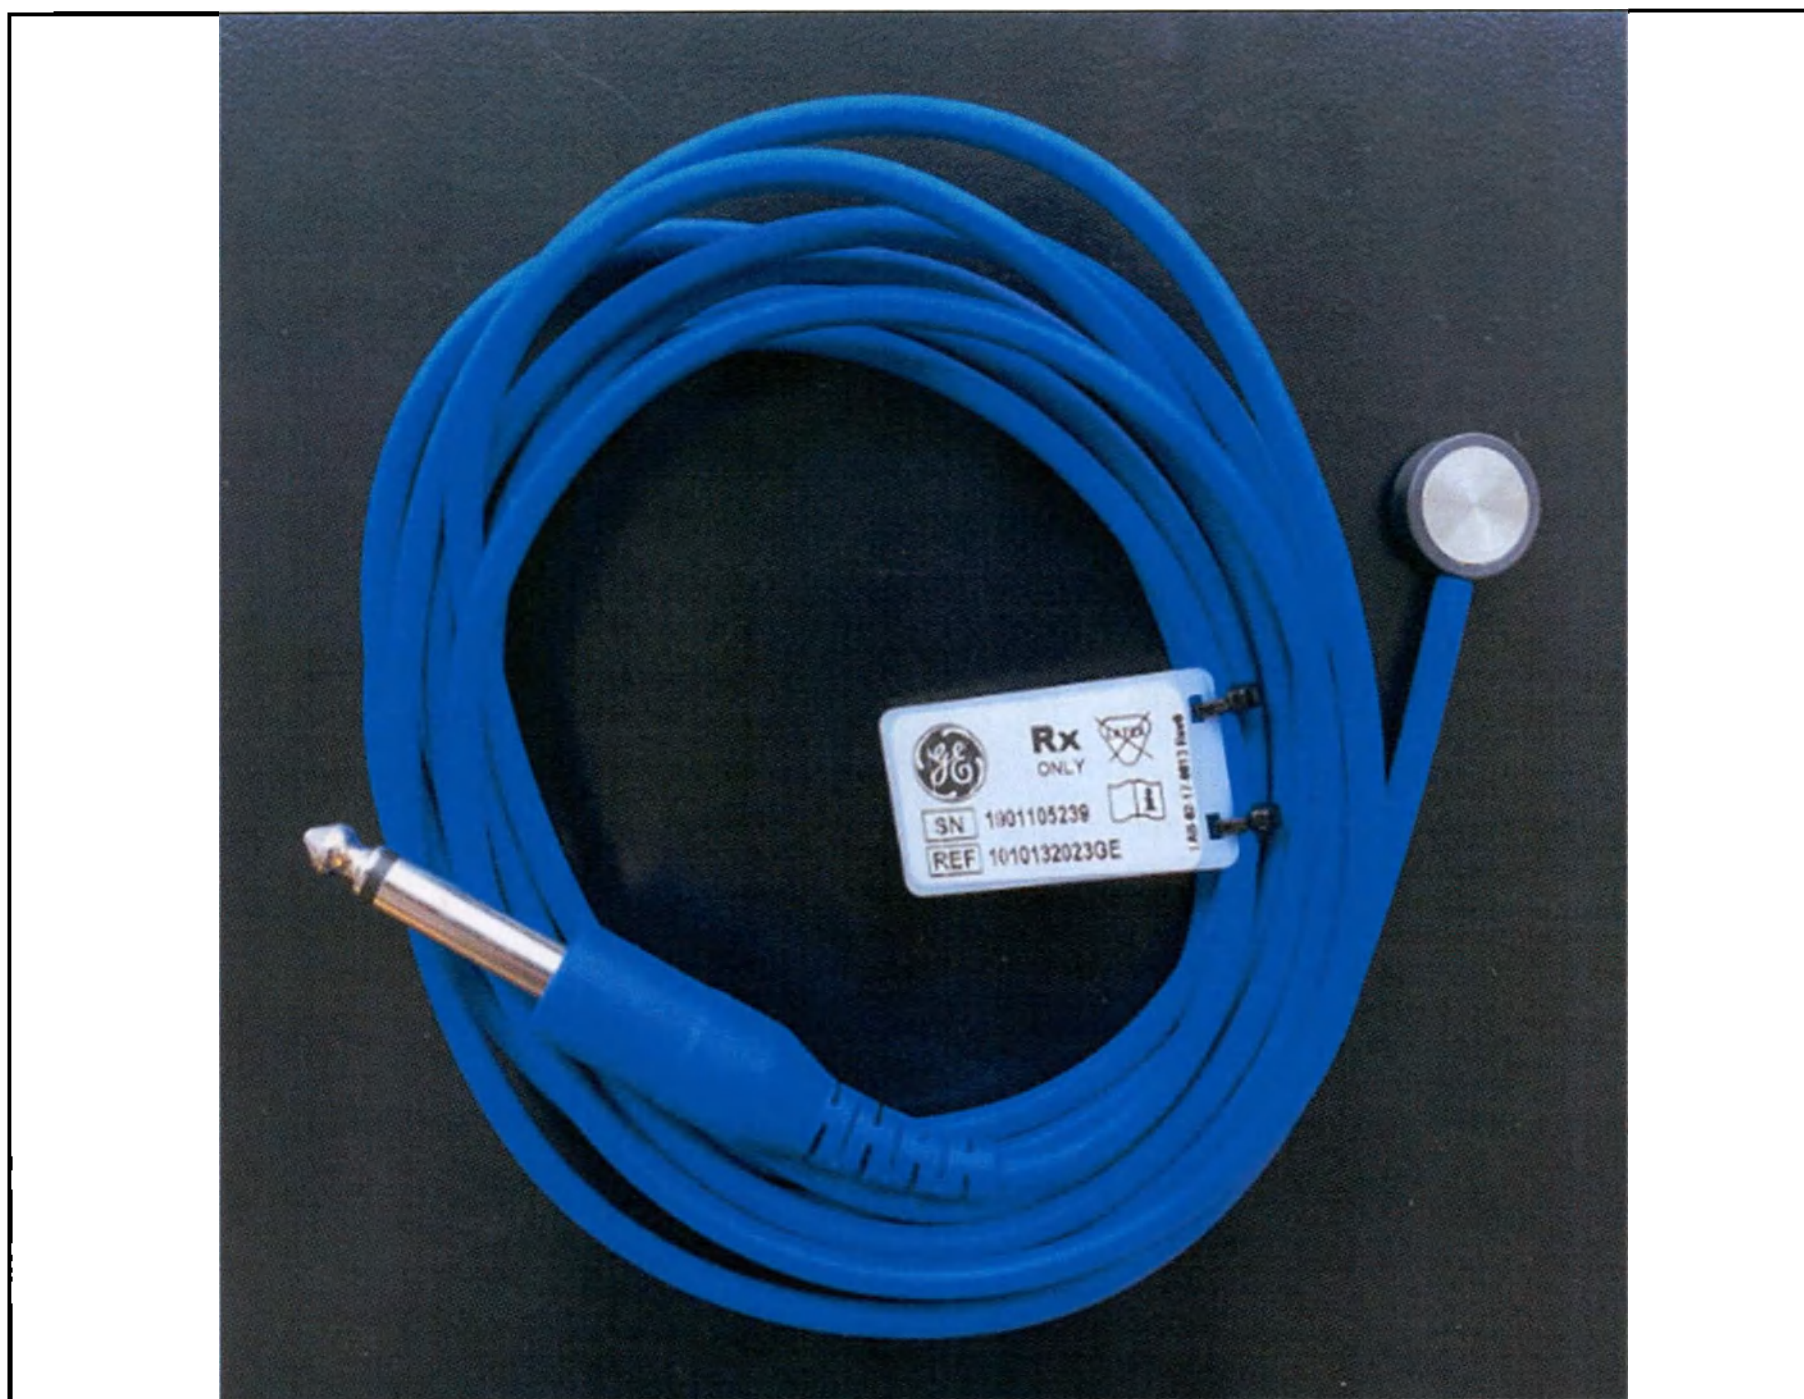


Рисунок 181. Накожный температурный датчик



Рисунок 182. Датчик общего назначения, серия 400, взрослый

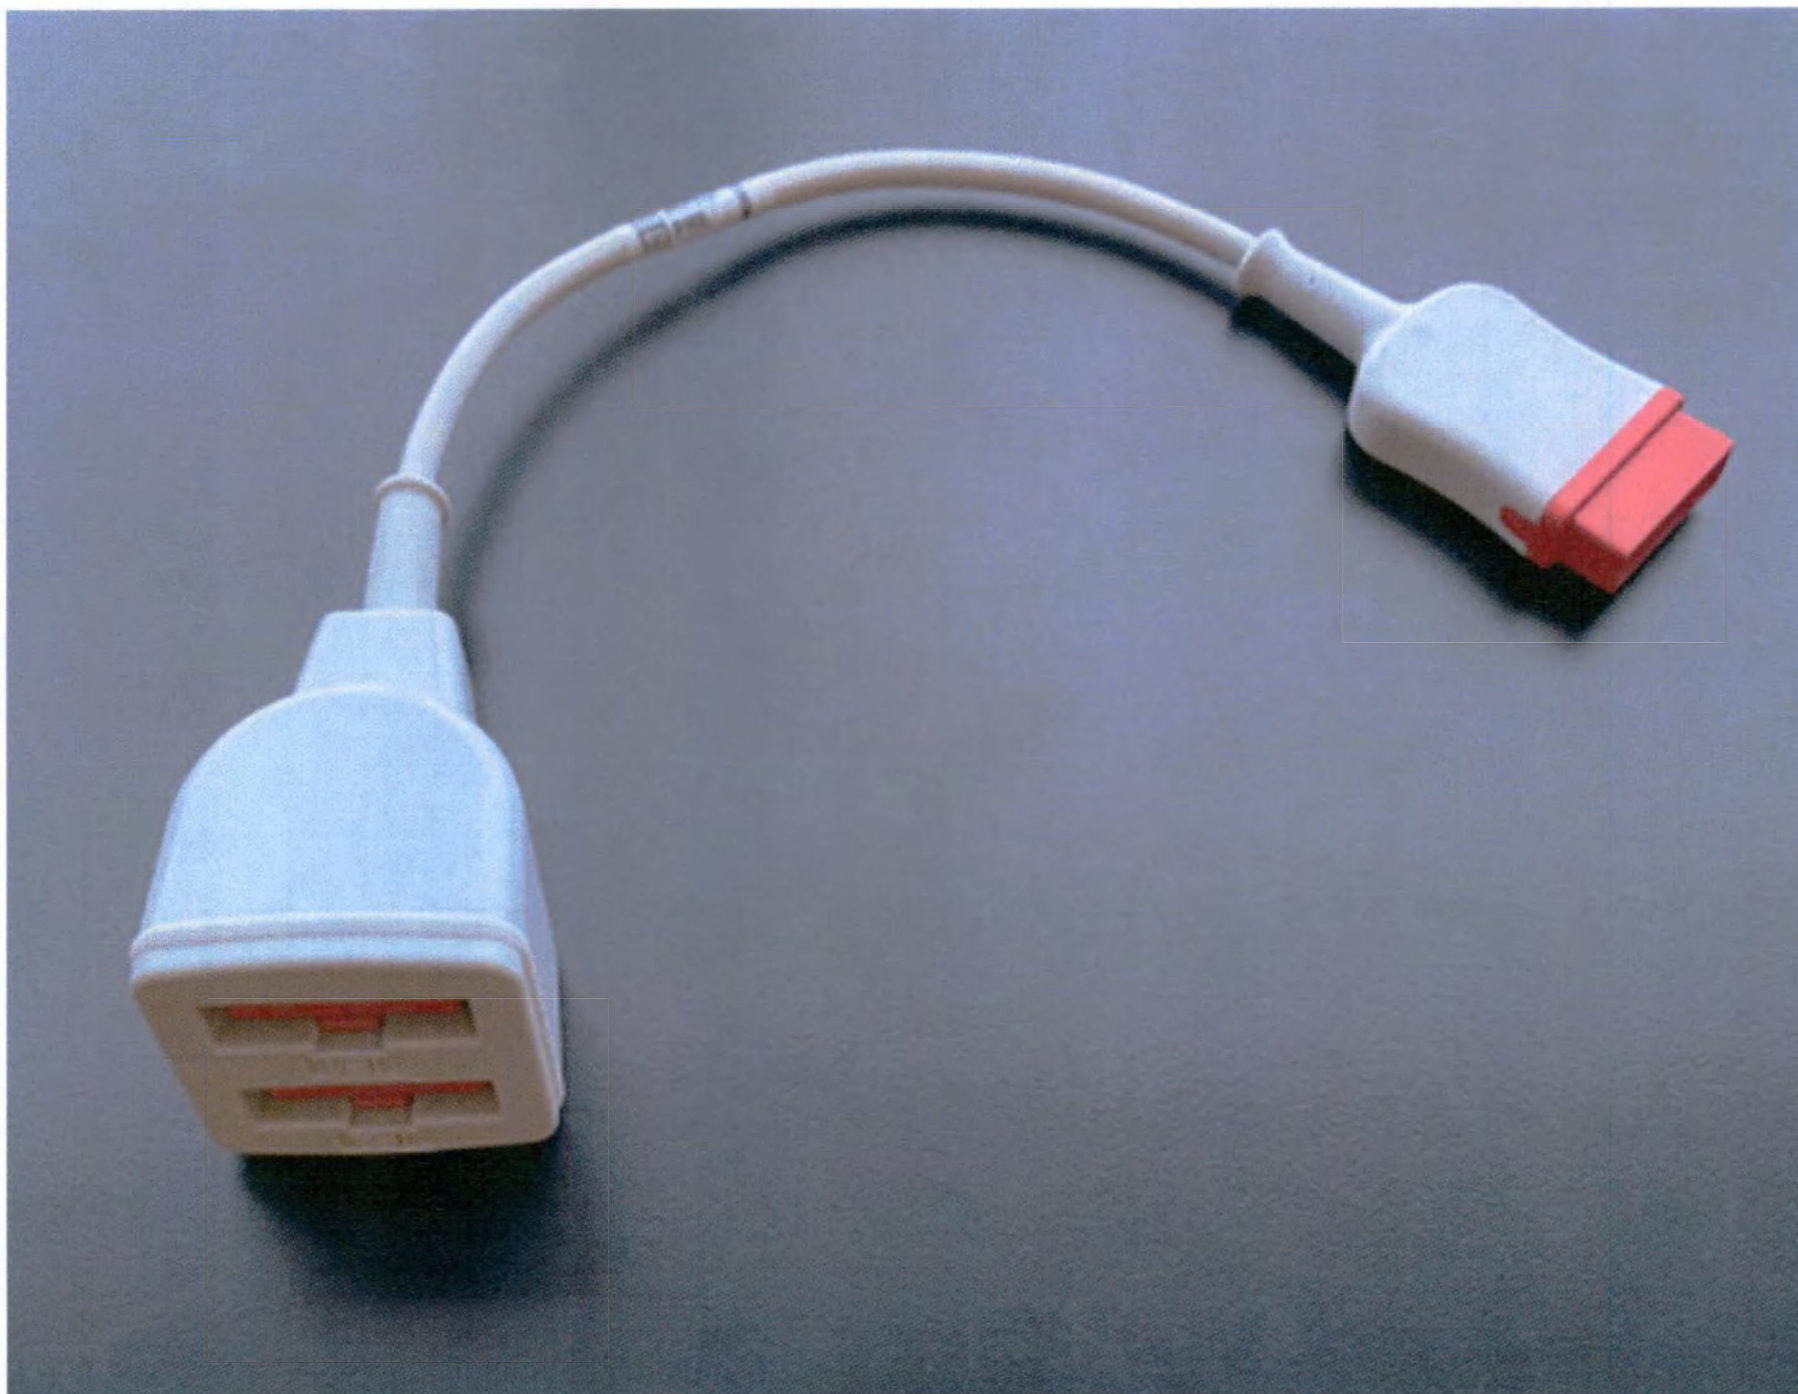


Рисунок 183. Кабель-адаптер Dual IBP, длина 30 см

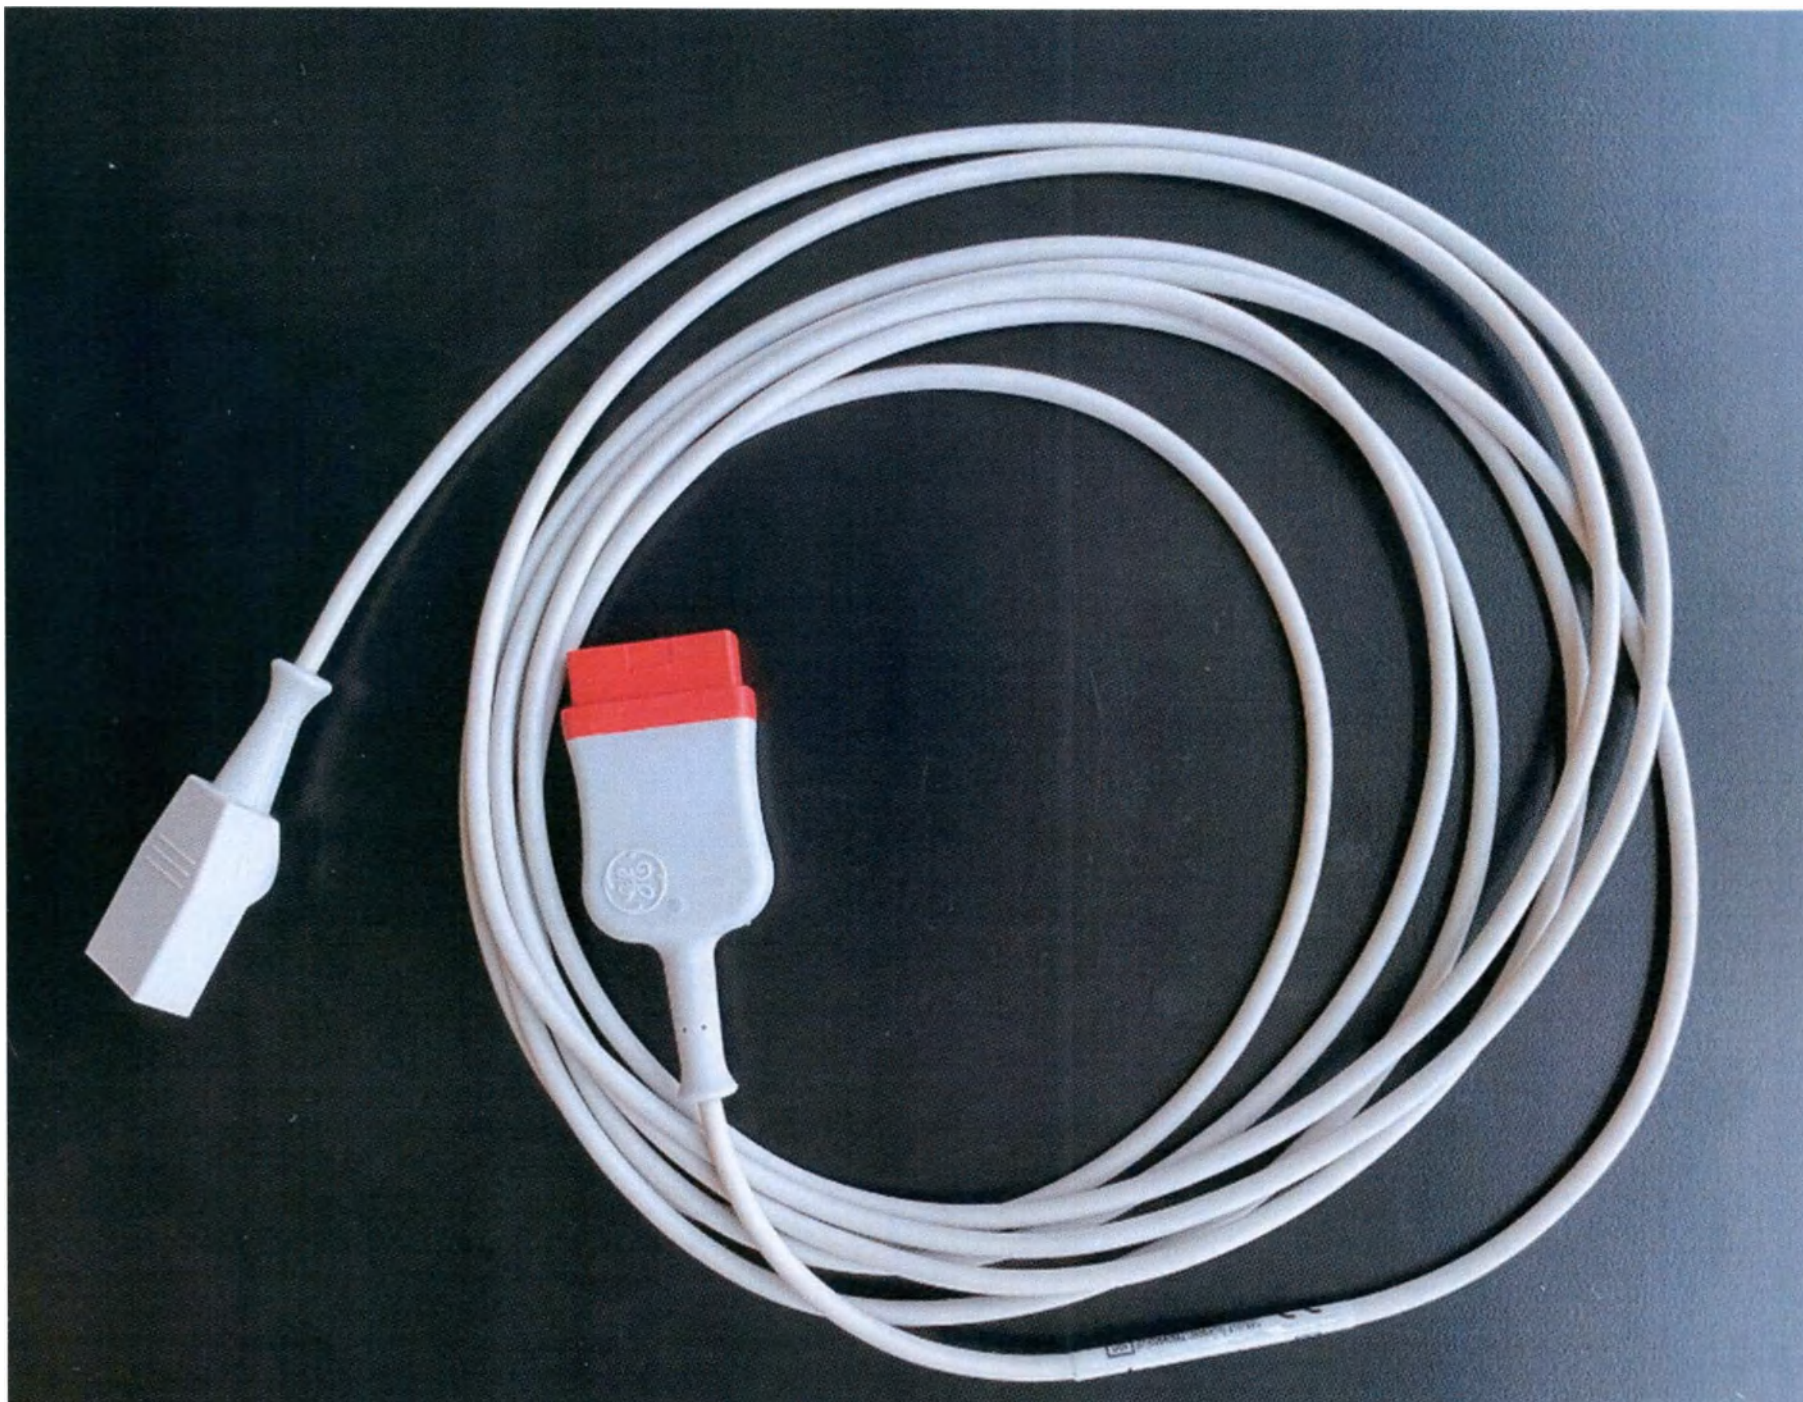


Рисунок 184. Кабель-адаптер датчика ИВР, длина 3,6 м

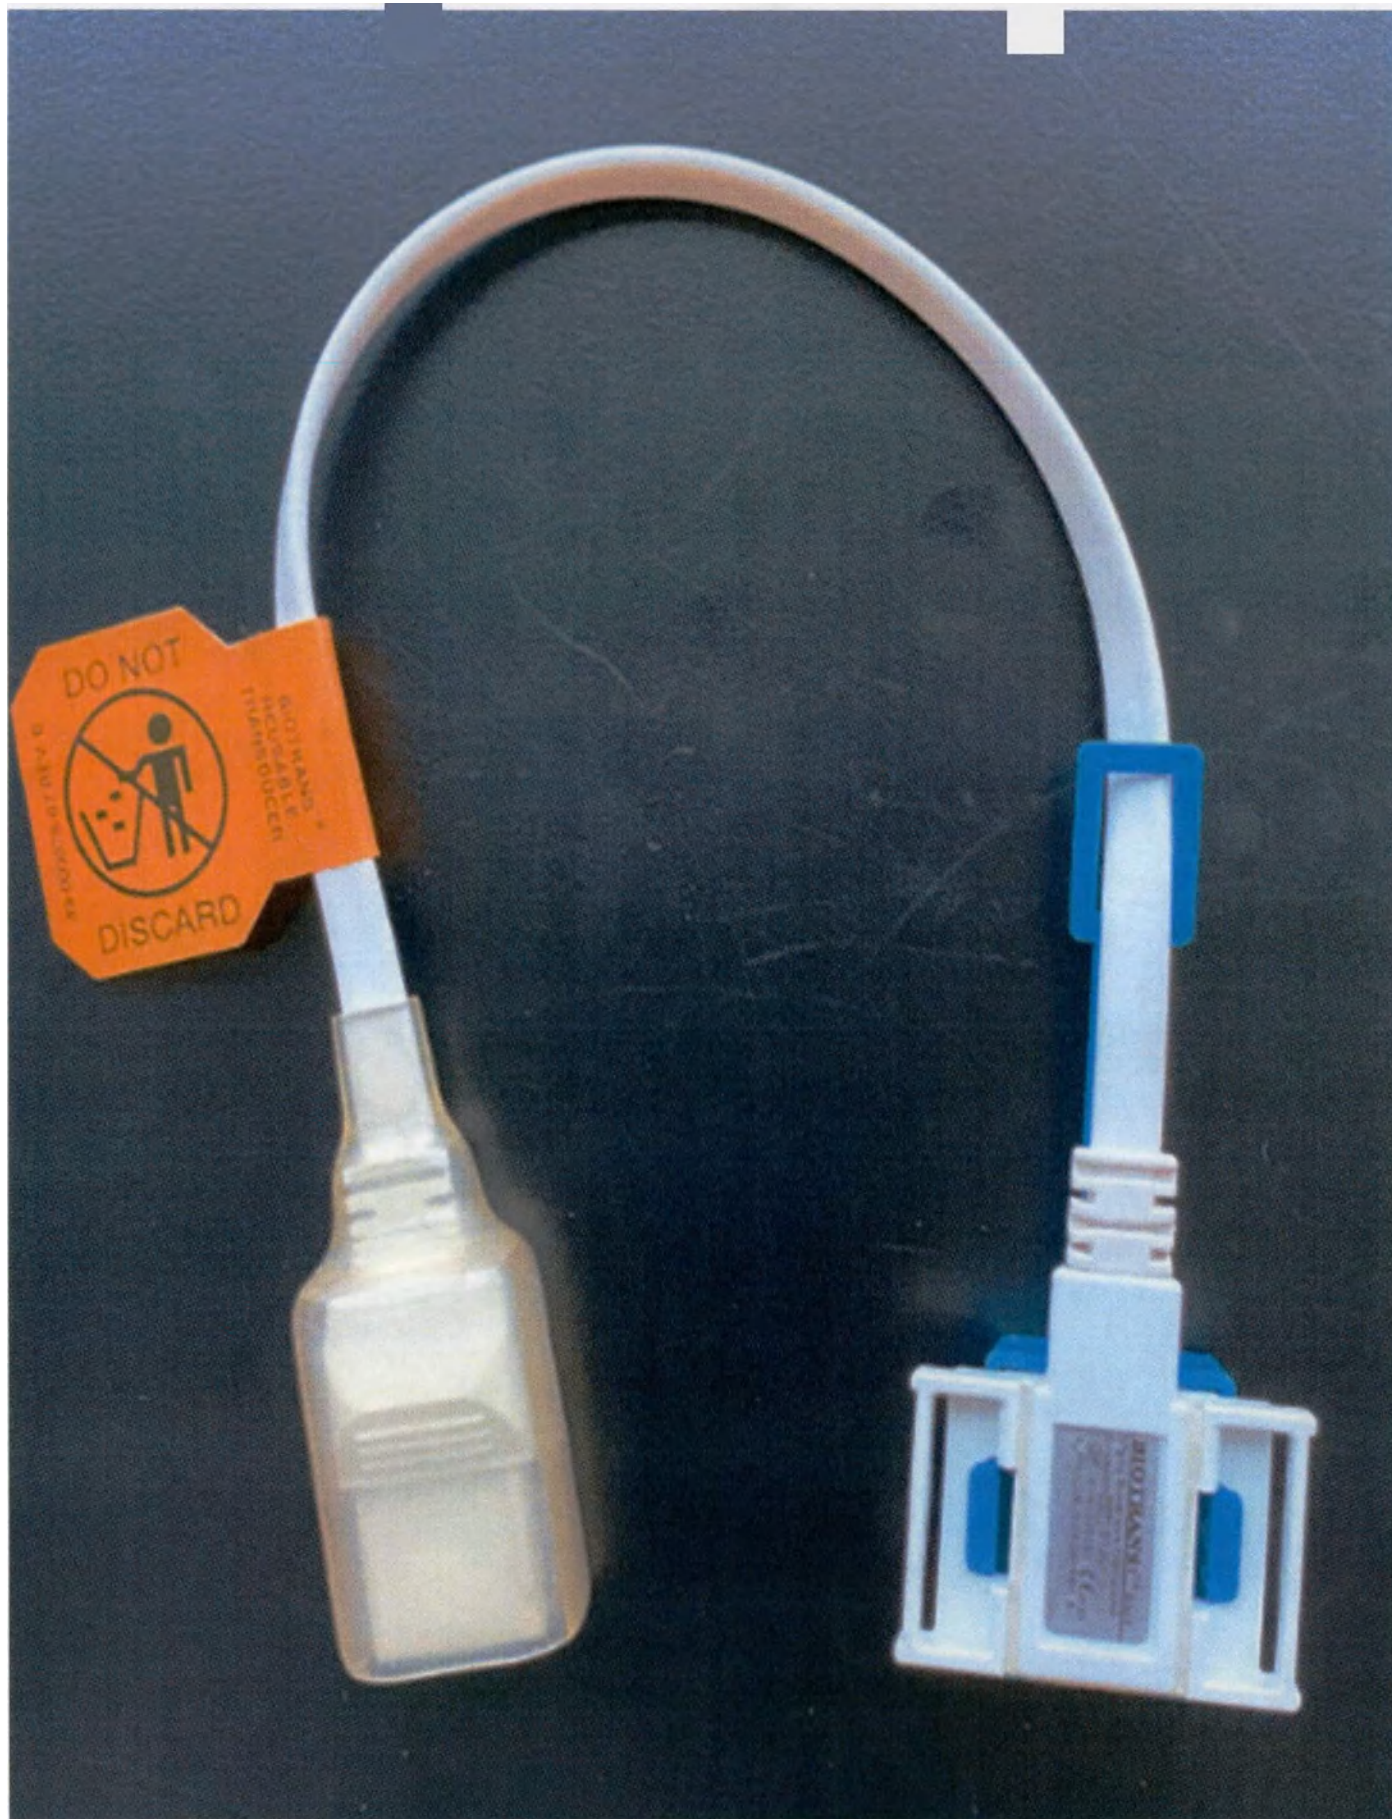


Рисунок 185. Подложка Biotrans

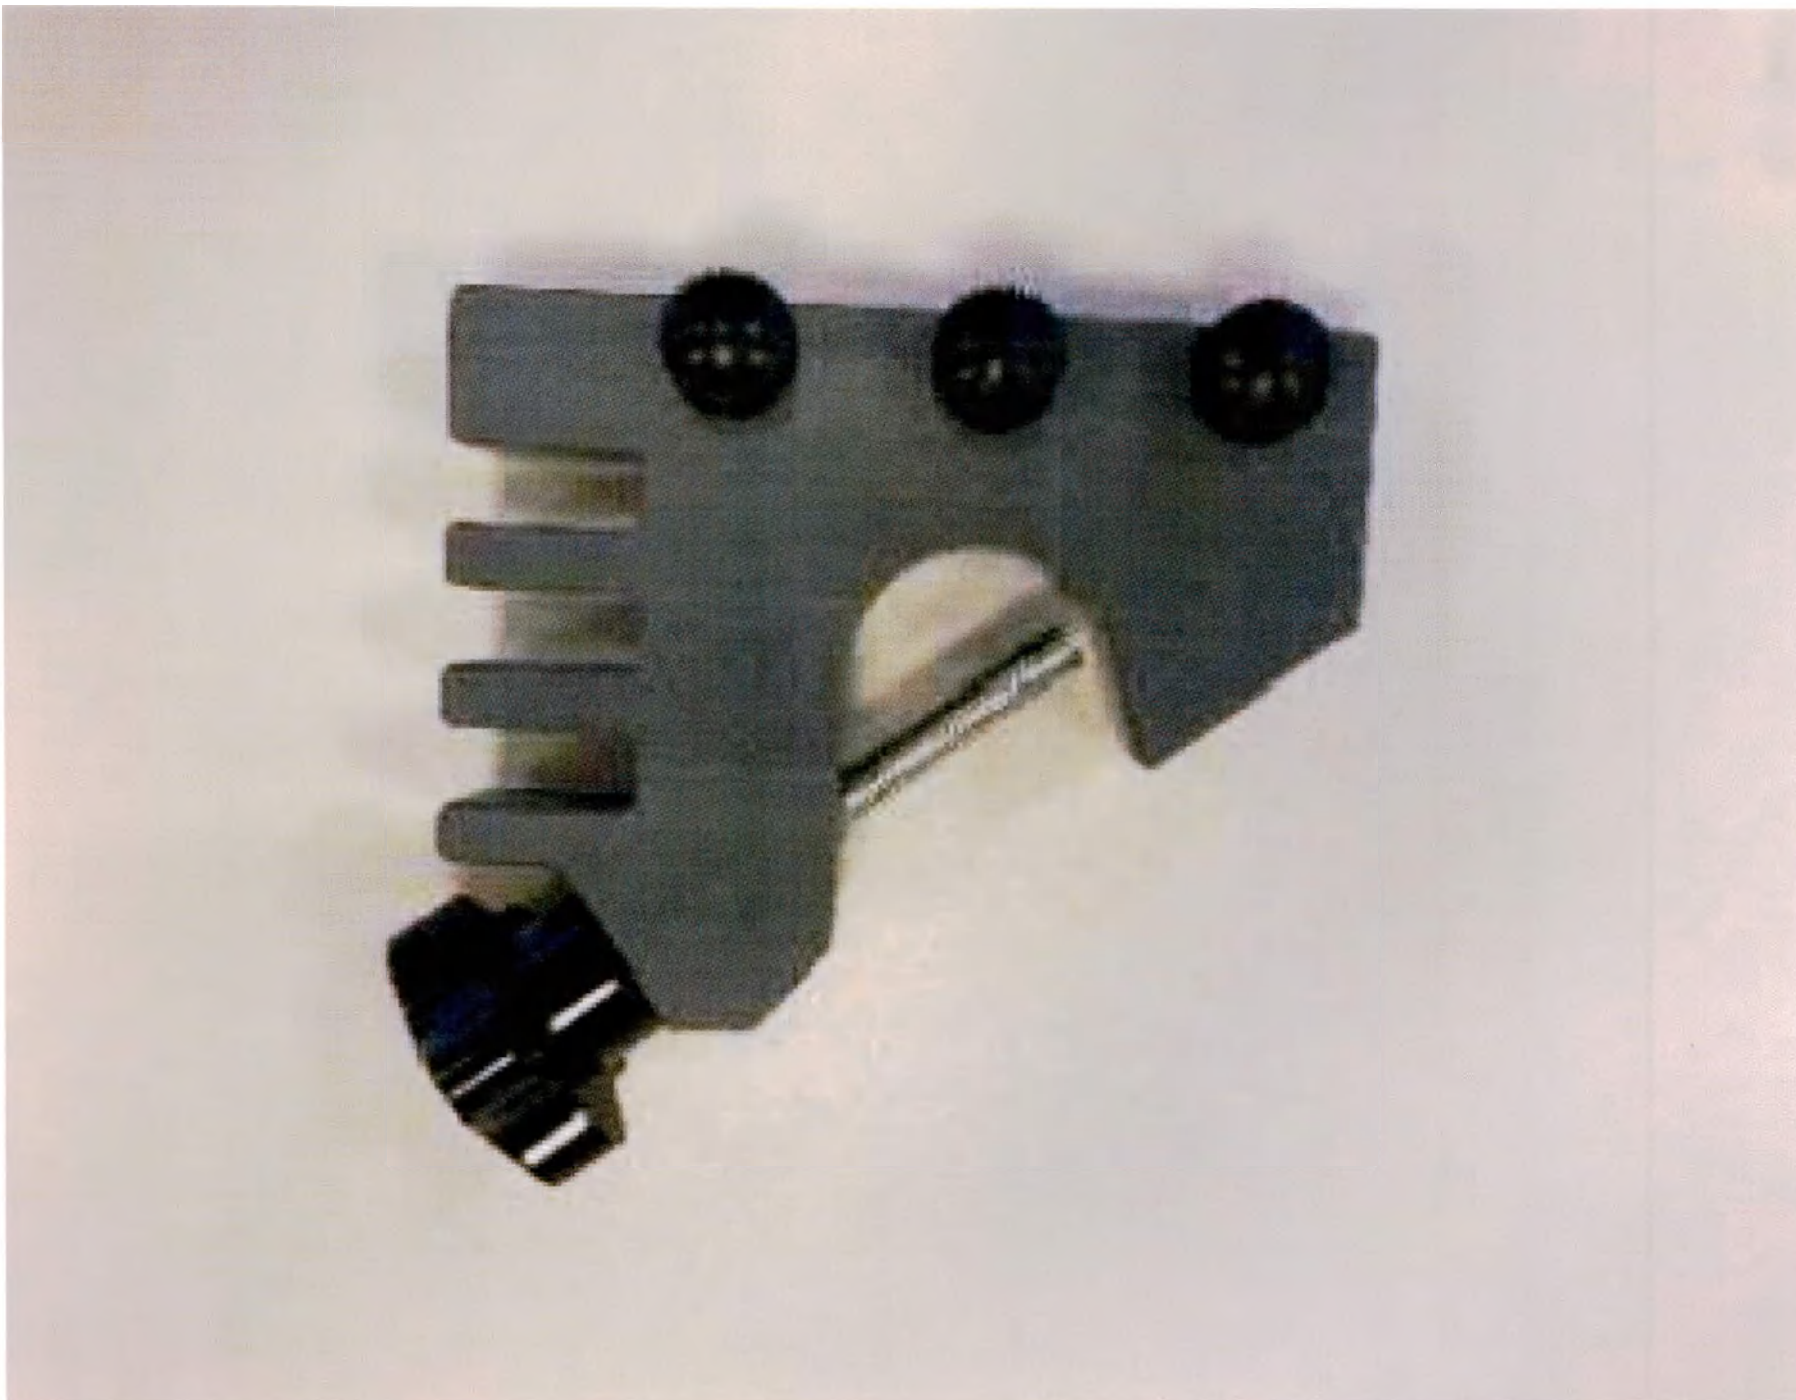


Рисунок 186. Клипс вертикального крепления

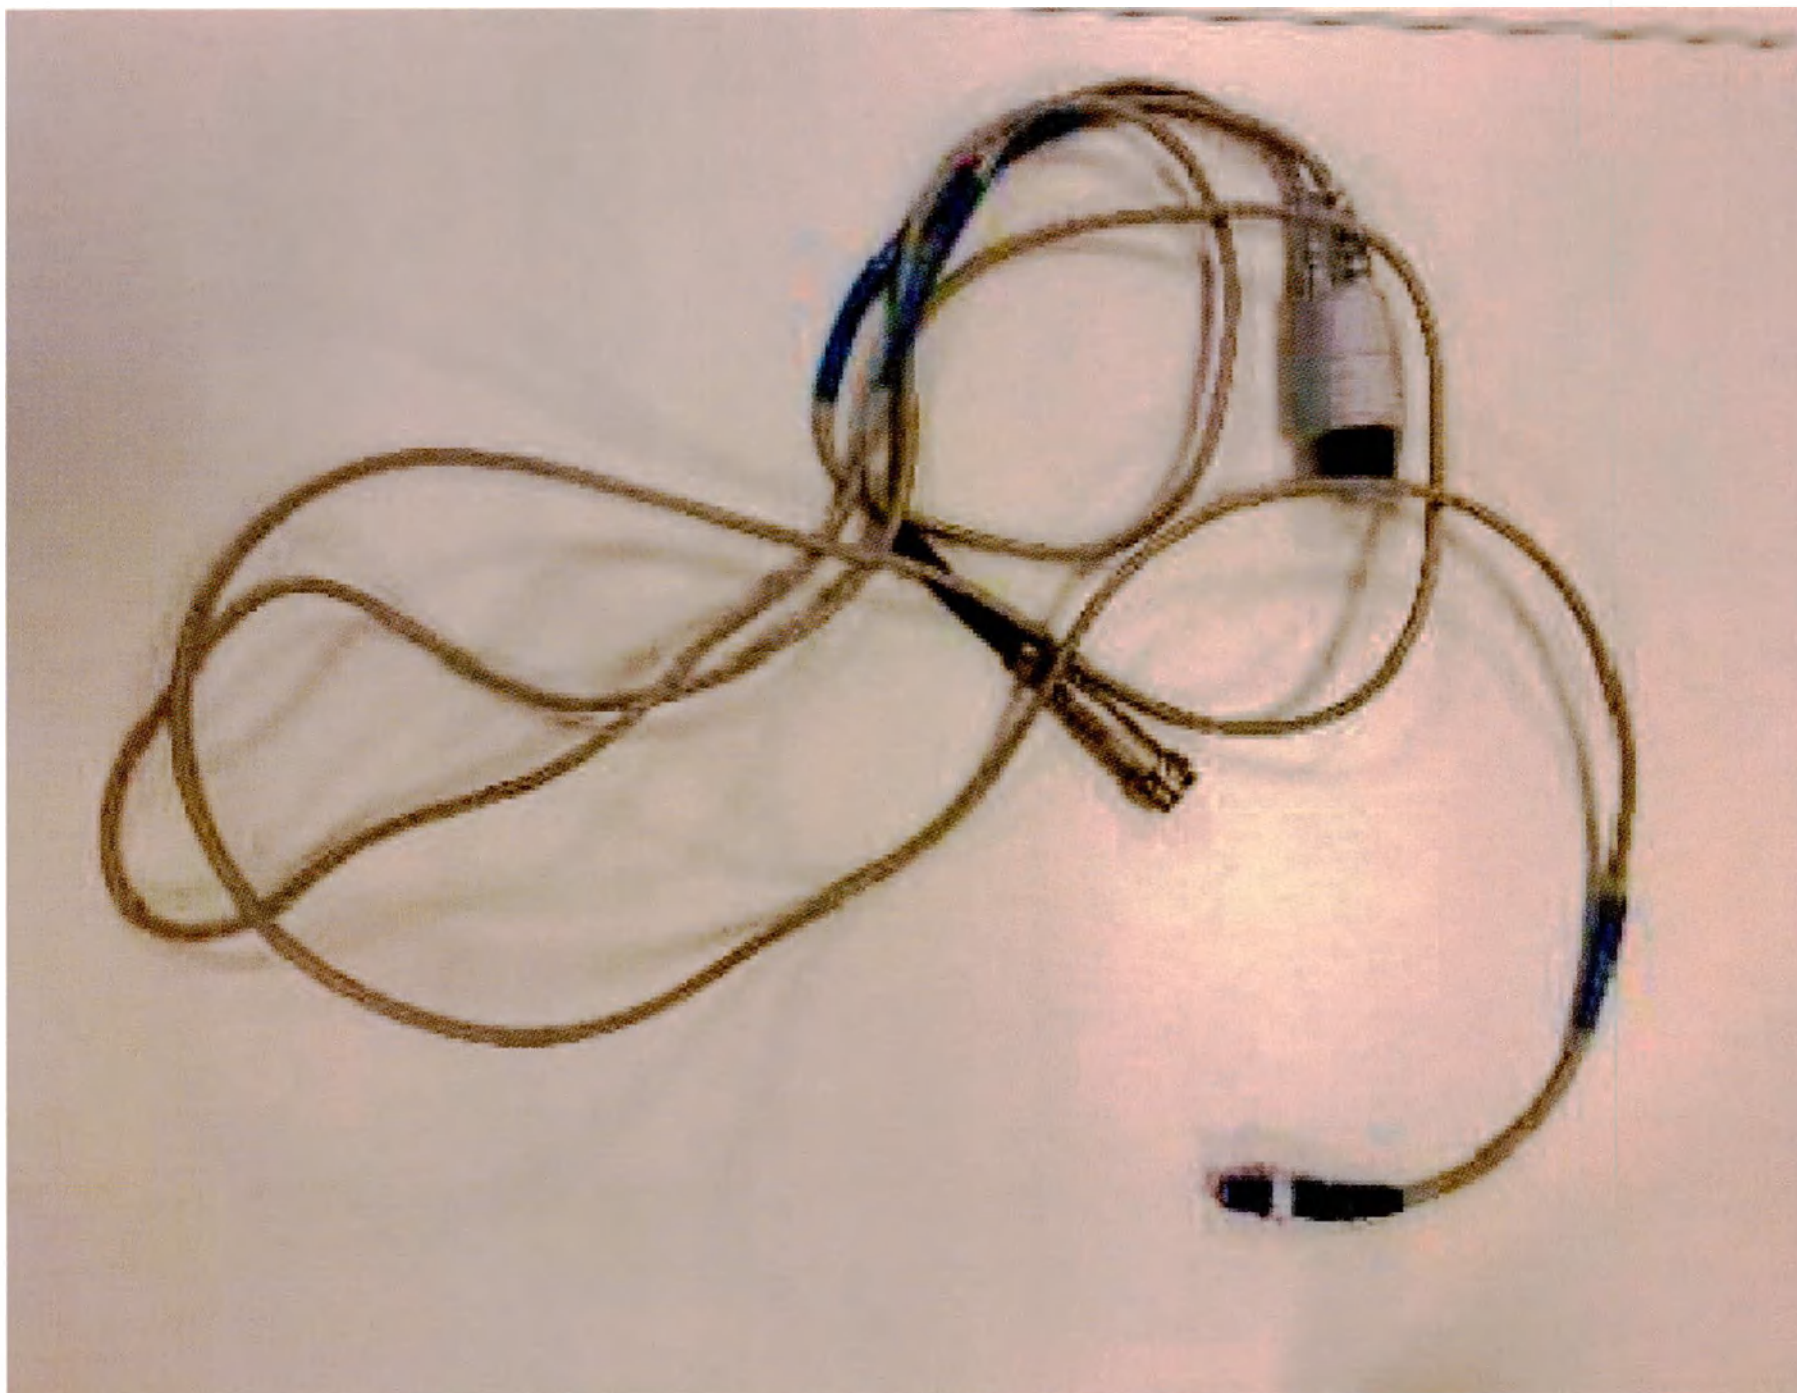


Рисунок 187. Кабель сердечного выброса, длина 3,6 м



Рисунок 188. Датчик вводимого вещества в трубке



Рисунок 189. Датчик температуры для системы введения растворов комнатной температуры



Рисунок 190. Кабель для подсоединения катетера


PN:	
	
Doc:	1 of 1
Date:	
Qty: 5	
Initial Name:	
Box#:	
For Receipt Forwarder Tag	

Рисунок 191. Программное обеспечение Centricity Enterprise Archive на оптических или электронных носителях



Рисунок 193. Модули дополнительные архивные для размещения медицинских изображений



Рисунок 192. Процессор комплекса программно-аппаратного Centricity Enterprise Archive для хранения диагностической медицинской информации

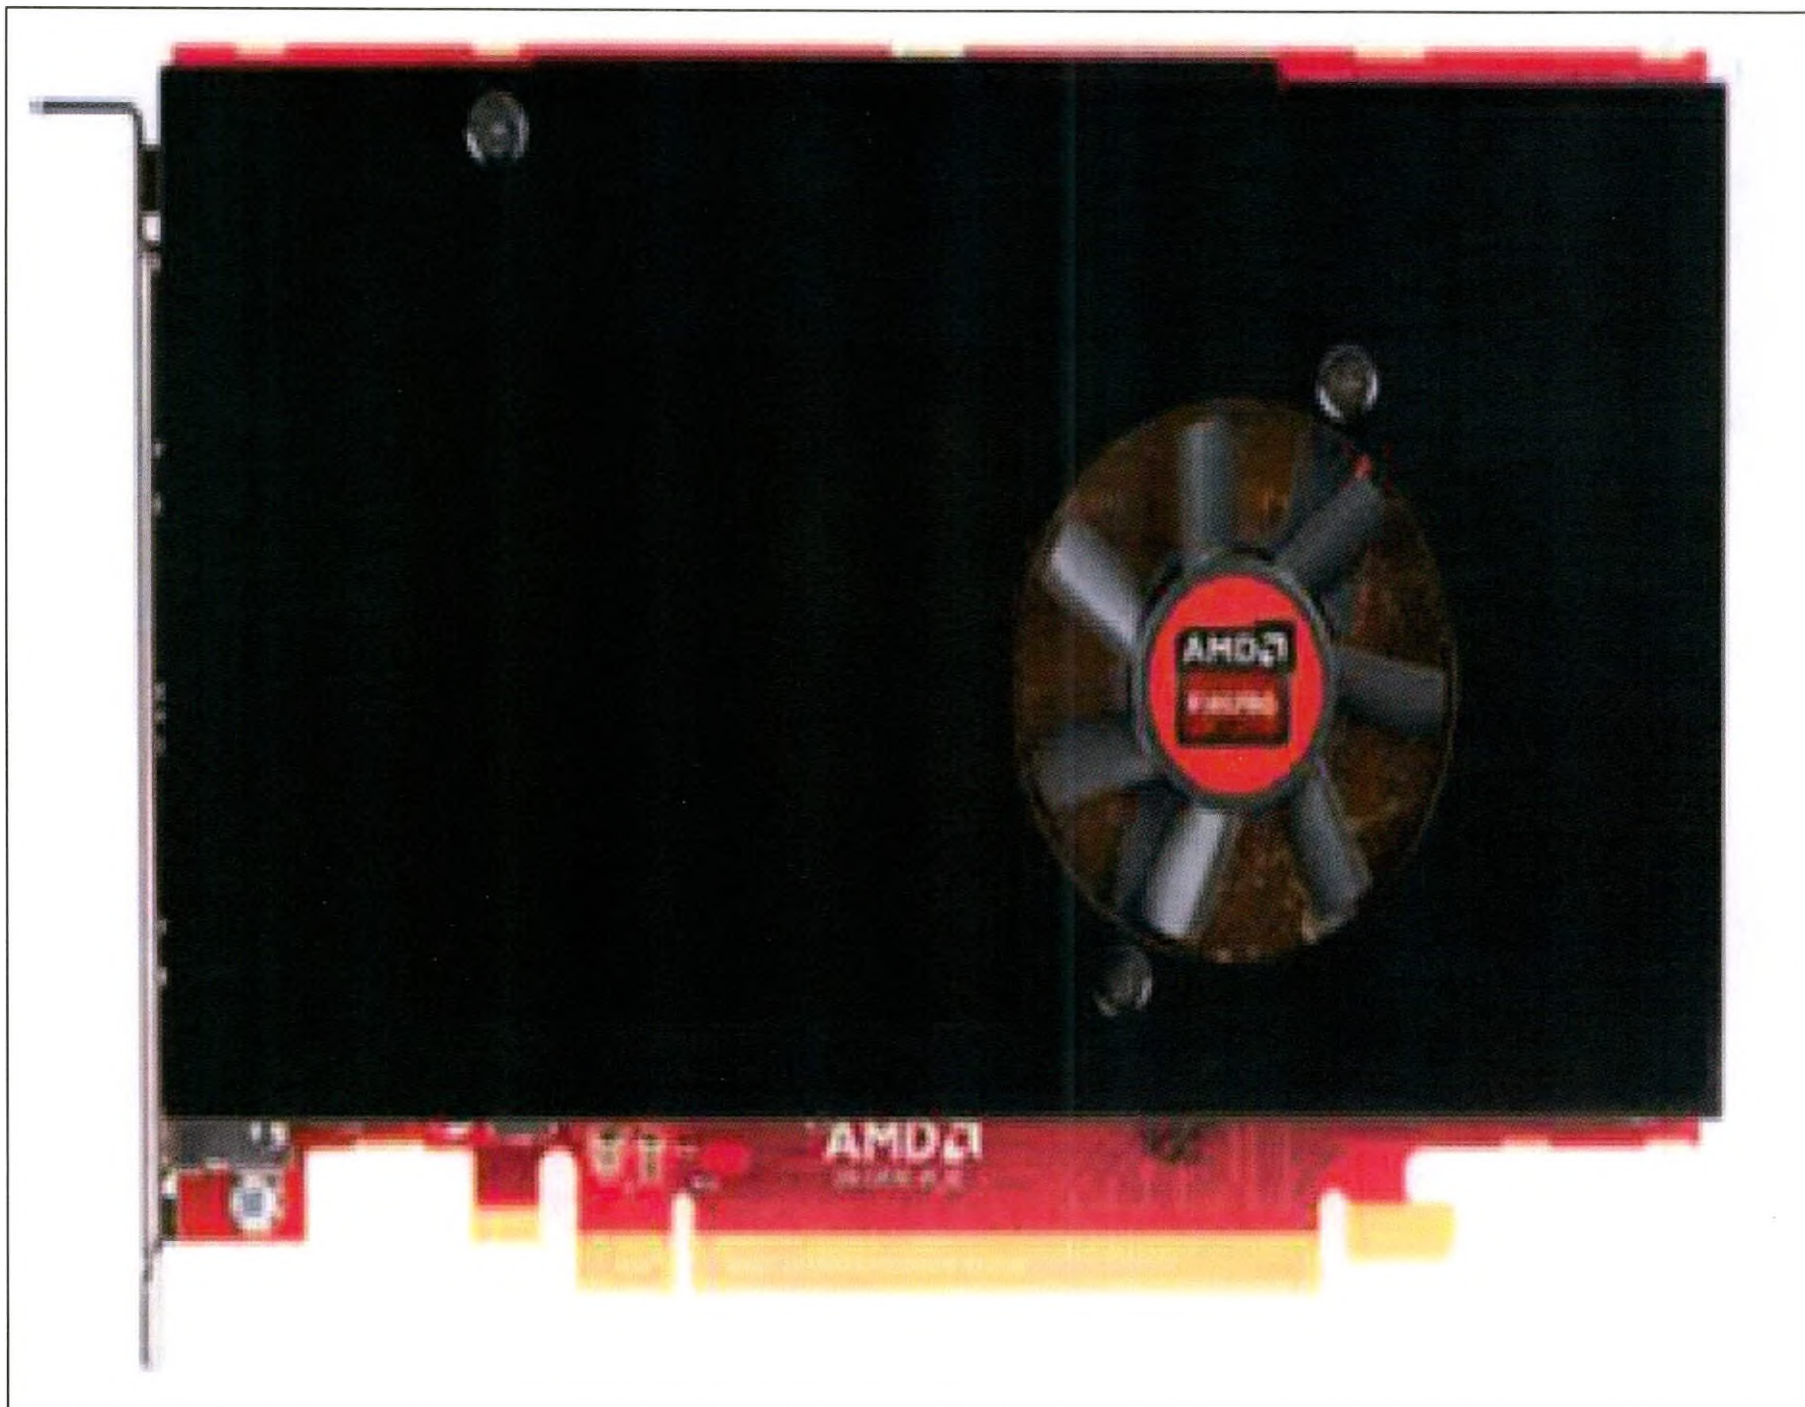


Рисунок 194. Видеокарты для ЖК мониторов

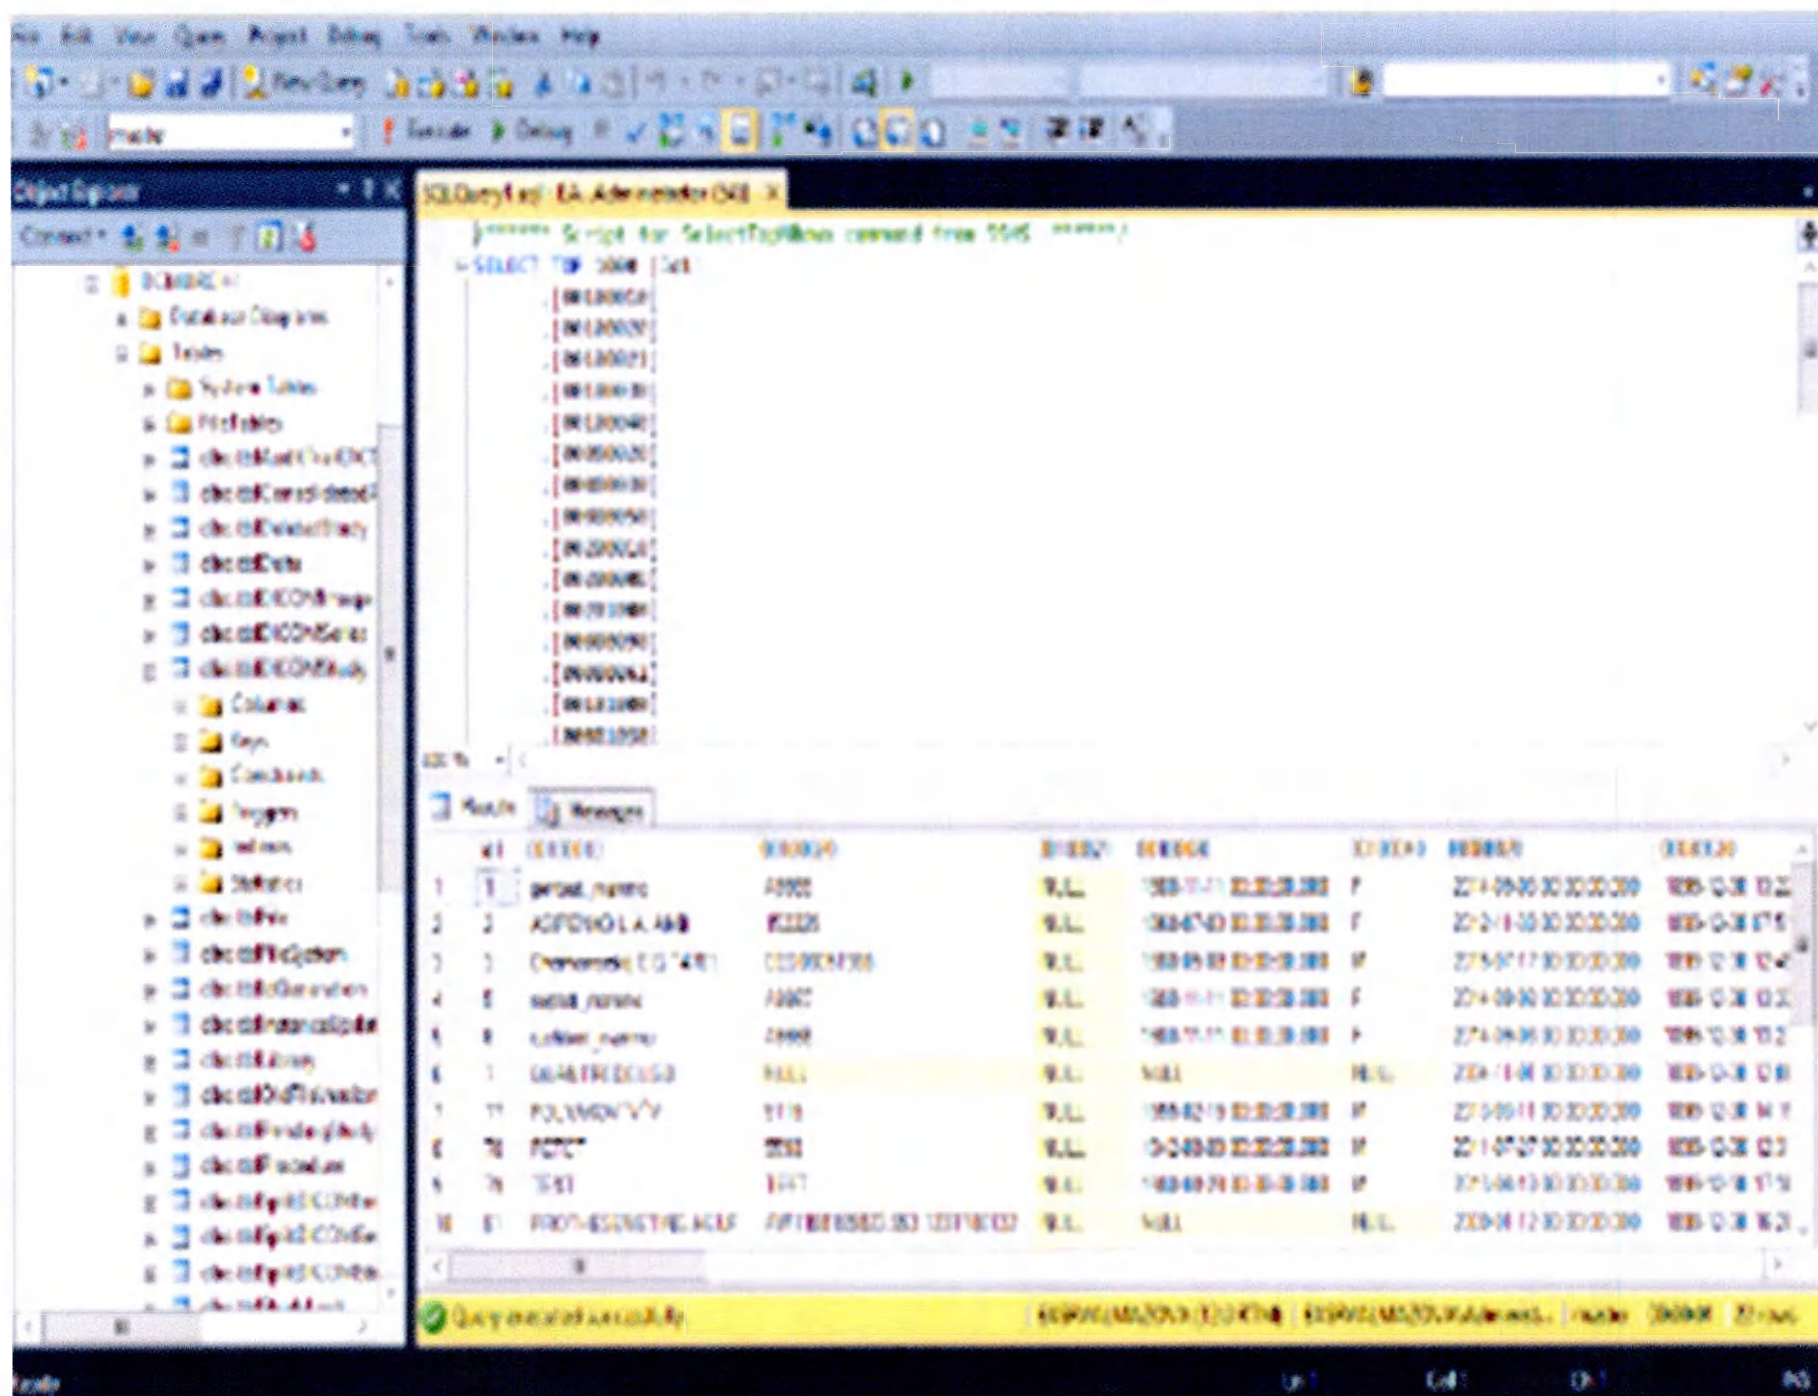


Рисунок 195. Электронный ключ для активации программного обеспечения системы управления базой данных на оптических или электронных или бумажных носителях комплекса Centricity Enterprise Archive

PN:		
Order	1 of 1	
SN:		
QTY: 1	For Freights For order Tax	
Install Notes		
Box#: _____		

Рисунок 196. Программный модуль для разворачивания операционной системы для Centricity Enterprise Archive

- > Activity
- > Communications
- > System
- > Tag Morphing
- > Messaging
- > Libraries
- > Prefetch
- > Database
- > Tools
- > ILM
- ▼ Help
 - Guide
 - About

About

Product:	Centricity Enterprise Archive 4.0
Licensed by:	GE Healthcare (Serial #: 345050064771)
Build:	6.230.51014.19532 SP23
License start date:	Tuesday, January 12, 2021
Storage capacity:	100000 procedures + 100000 procedures per year
# of archives:	300 Archives
HL7 support:	Yes
BroadView(Speedspan):	Yes
DICOM Retrieve:	Yes
Image Lifecycle Management	Yes
XDS	Yes
Load balance	Yes
Tag Morphing	Yes
Data Migration	Yes

UDI
(01)00840682102766(10)4.0P232093659001D



R_x Only



Consult instructions for use



EC REP

CE MD

Рисунок 197. Лицензия Centricity Enterprise Archive на фиксированное количество входящих исследований в год

PN: 	
Desc:	1 of 1
S/N:	
QTY: 1 Initial Name:	
Box#:	

For
 Freight
 Forwarder
 Tag

Рисунок 198. Электронный ключ для активации лицензии на интеграцию системы с электронной картой пациента

PN:	
	
Desc:	1 of 1
S/N:	
QTY: 1 Instal Notes:	
Box#: _____	

For
Freight
Forwarder
Tag

Рисунок 199. Электронный ключ для активации лицензии на интеграцию системы через API-интерфейс с другими информационными системами GE

PN: 	
Desc:	1 of 1
S/N:	
QTY: 1 Instal Name:	
Box#:	

For
 Freight
 Forwarder
 Tag

Рисунок 200. Электронный ключ для активации лицензии Centricity Clinical Gateway

PN: 	
Desc:	1 of 1
S/N:	
QTY: 1 Instal Notes:	
Box#:	
For Freight Forwarder Tag	

Рисунок 201. Программный модуль Zero Foot Print для организации клиентского доступа к системе Centricity Universal Viewer



GE Healthcare

GE Healthcare, Integrated IT Solutions Dynamic Imaging Solutions

Centricity Zero Foot Print Viewer

Congratulations regarding your institution's decision
to purchase GE Centricity® PACS software!

This certificate represents the purchase of a system license.

Any required product configuration will be coordinated through our service organization.

GE Healthcare
Global Order Number

2993672,1

GE Healthcare Dynamic Imaging
Solutions Catalog Part Number

K20371T

Quantity - 15

Catalog Description

Centricity ZFP <25k/K exams per year

PRINTED ON RECYCLED PAPER

Рисунок 202. Лицензия Zero Foot Print для организации клиентского доступа к системе Centricity Universal Viewer на фиксированное количество входящих исследований в год

PN:	
	
Desc:	1 of 1
S/N:	
QTY: 1	For Freight Forwarder Tag
Install Notes:	
Box#:	

Рисунок 203. Расширение лицензии Zero Foot Print для организации клиентского доступа к системе Centricity Universal Viewer на фиксированное число входящих исследований в год



Рисунок 204. Шкафы серверные



Рисунок 205. Рабочие станции серверного типа для работы с функциональными изображениями



Рисунок 206. Автоматизированные рабочие места врачей



Рисунок 207. Мониторы диагностические медицинские для врачей

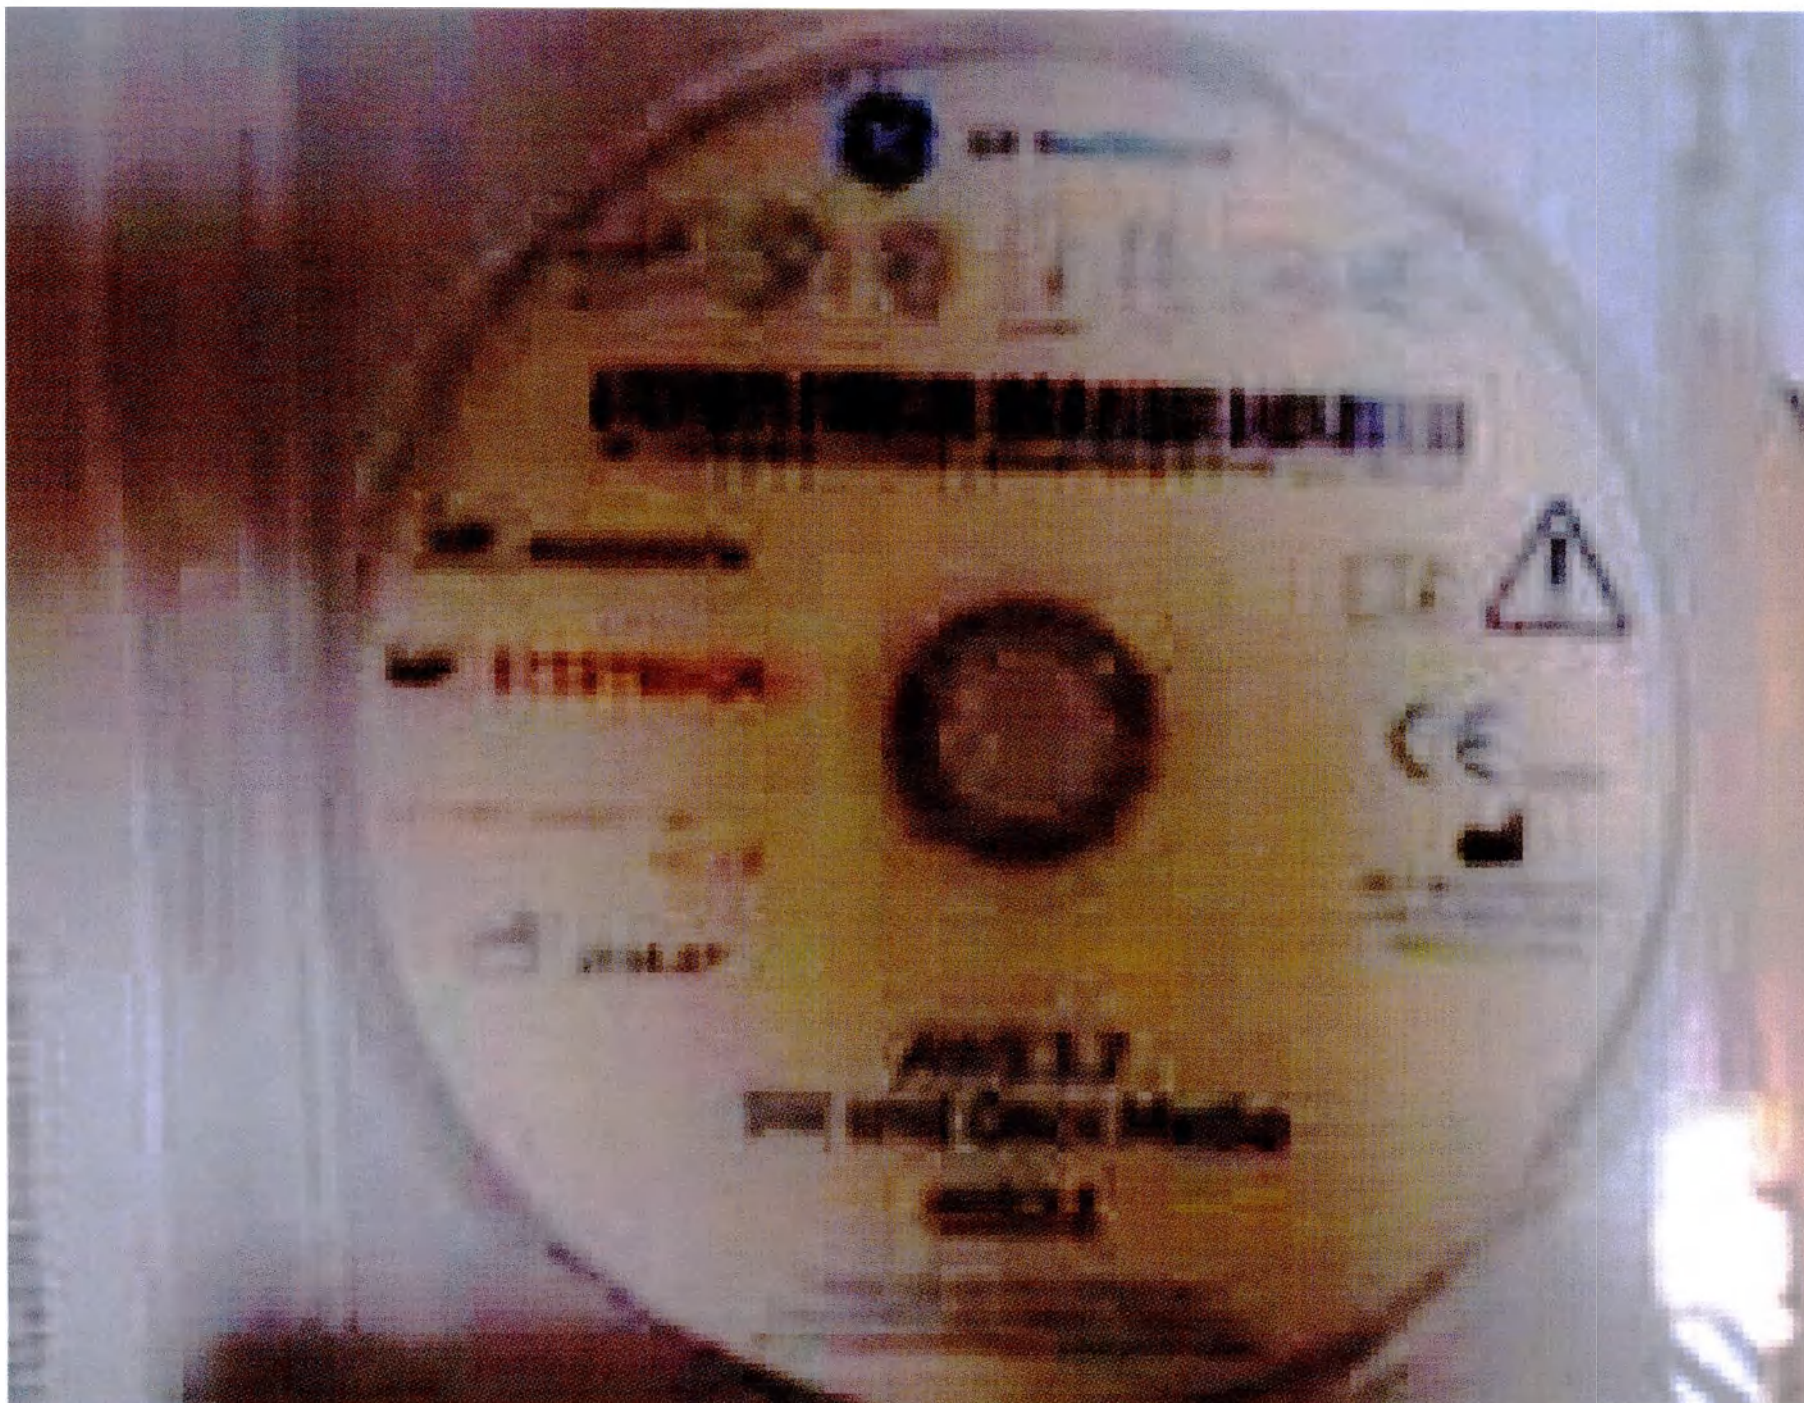


Рисунок 208. Лицензия на одно клиентское место на запуск клинического приложения

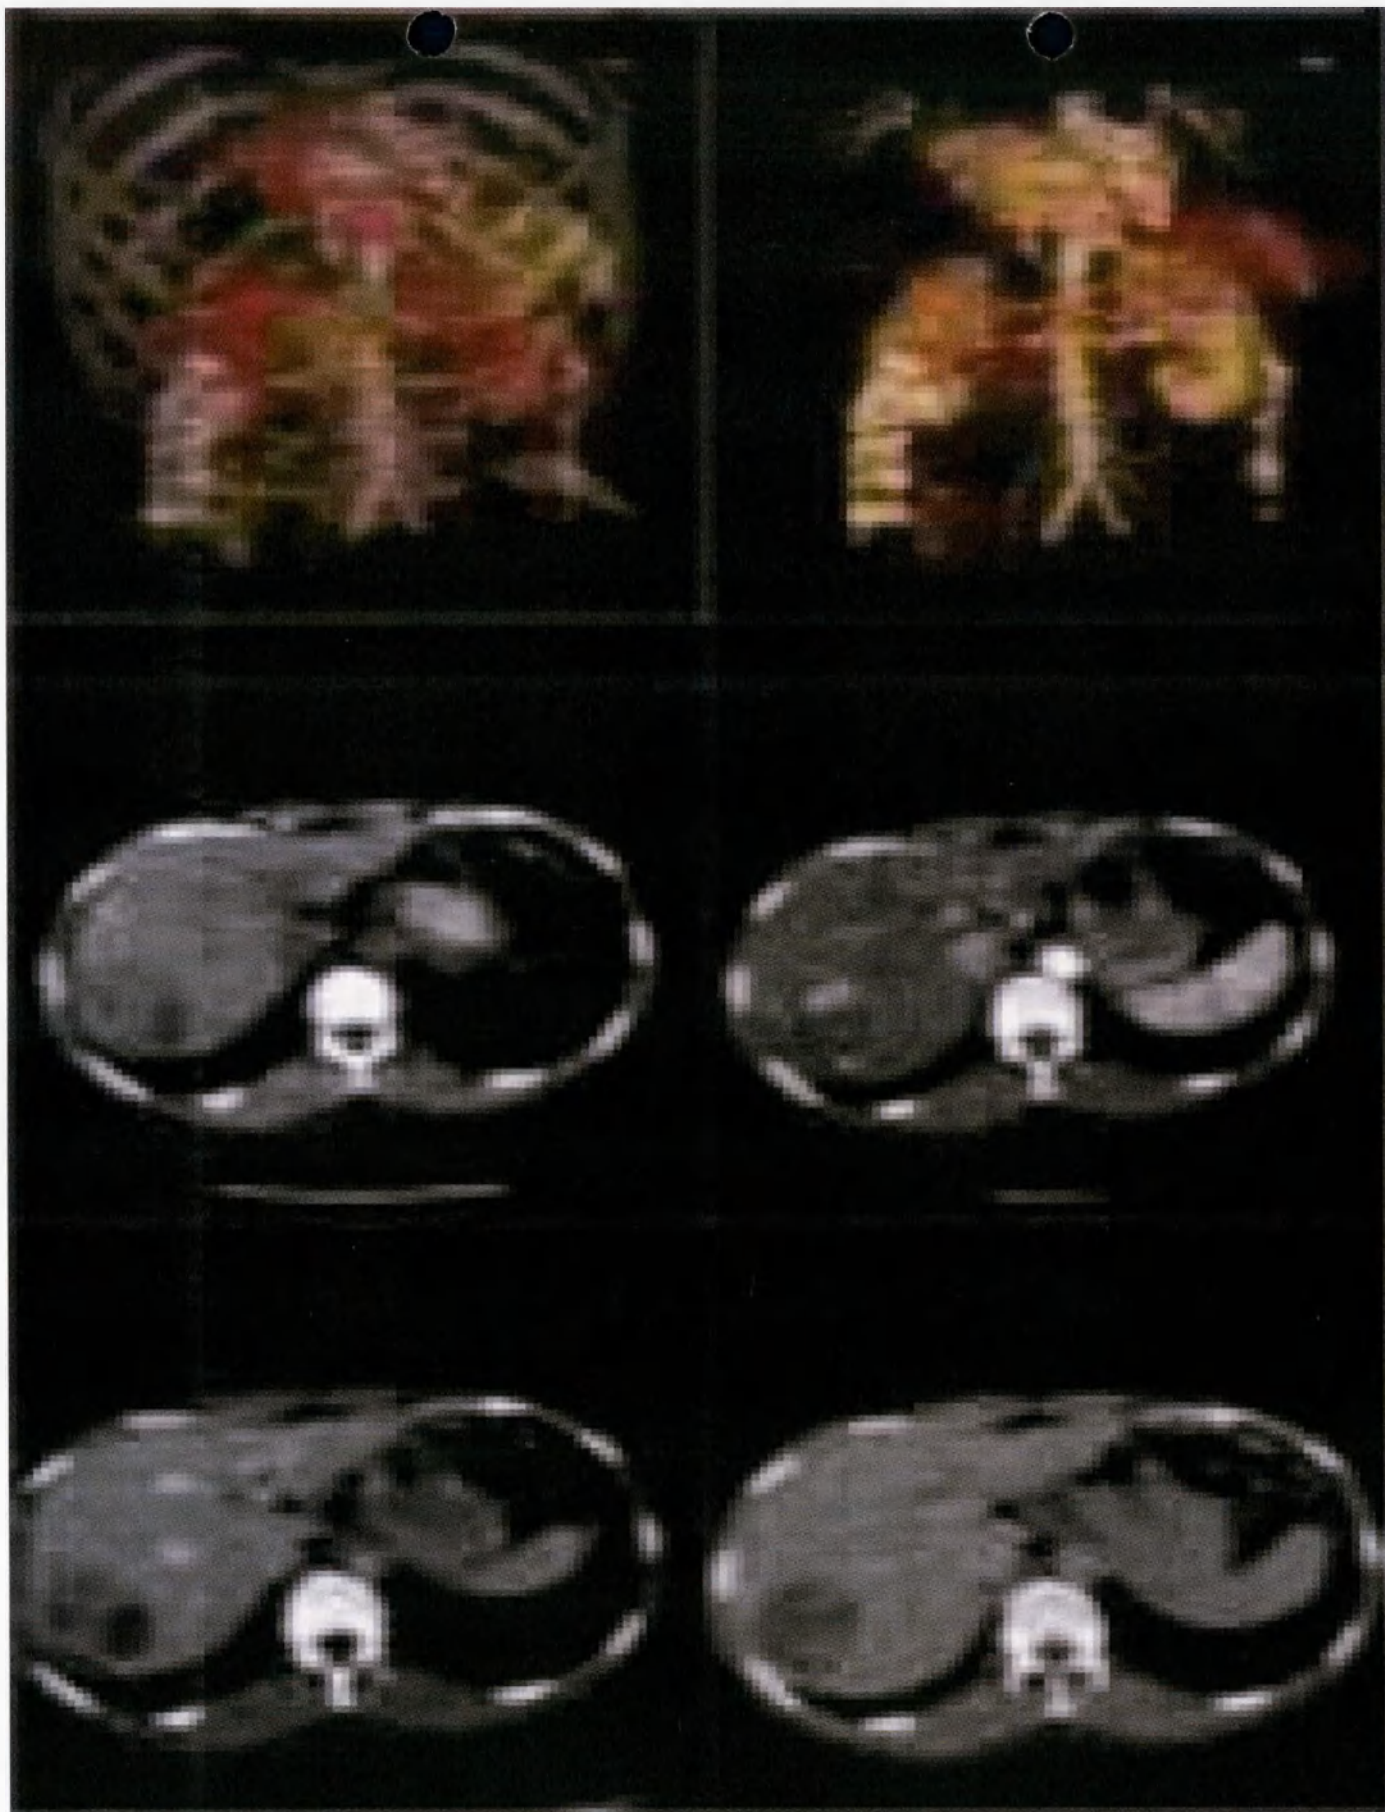


Рисунок 209. Конкурентная клиентская лицензия на запуск клинического приложения Volume Viewer Digital

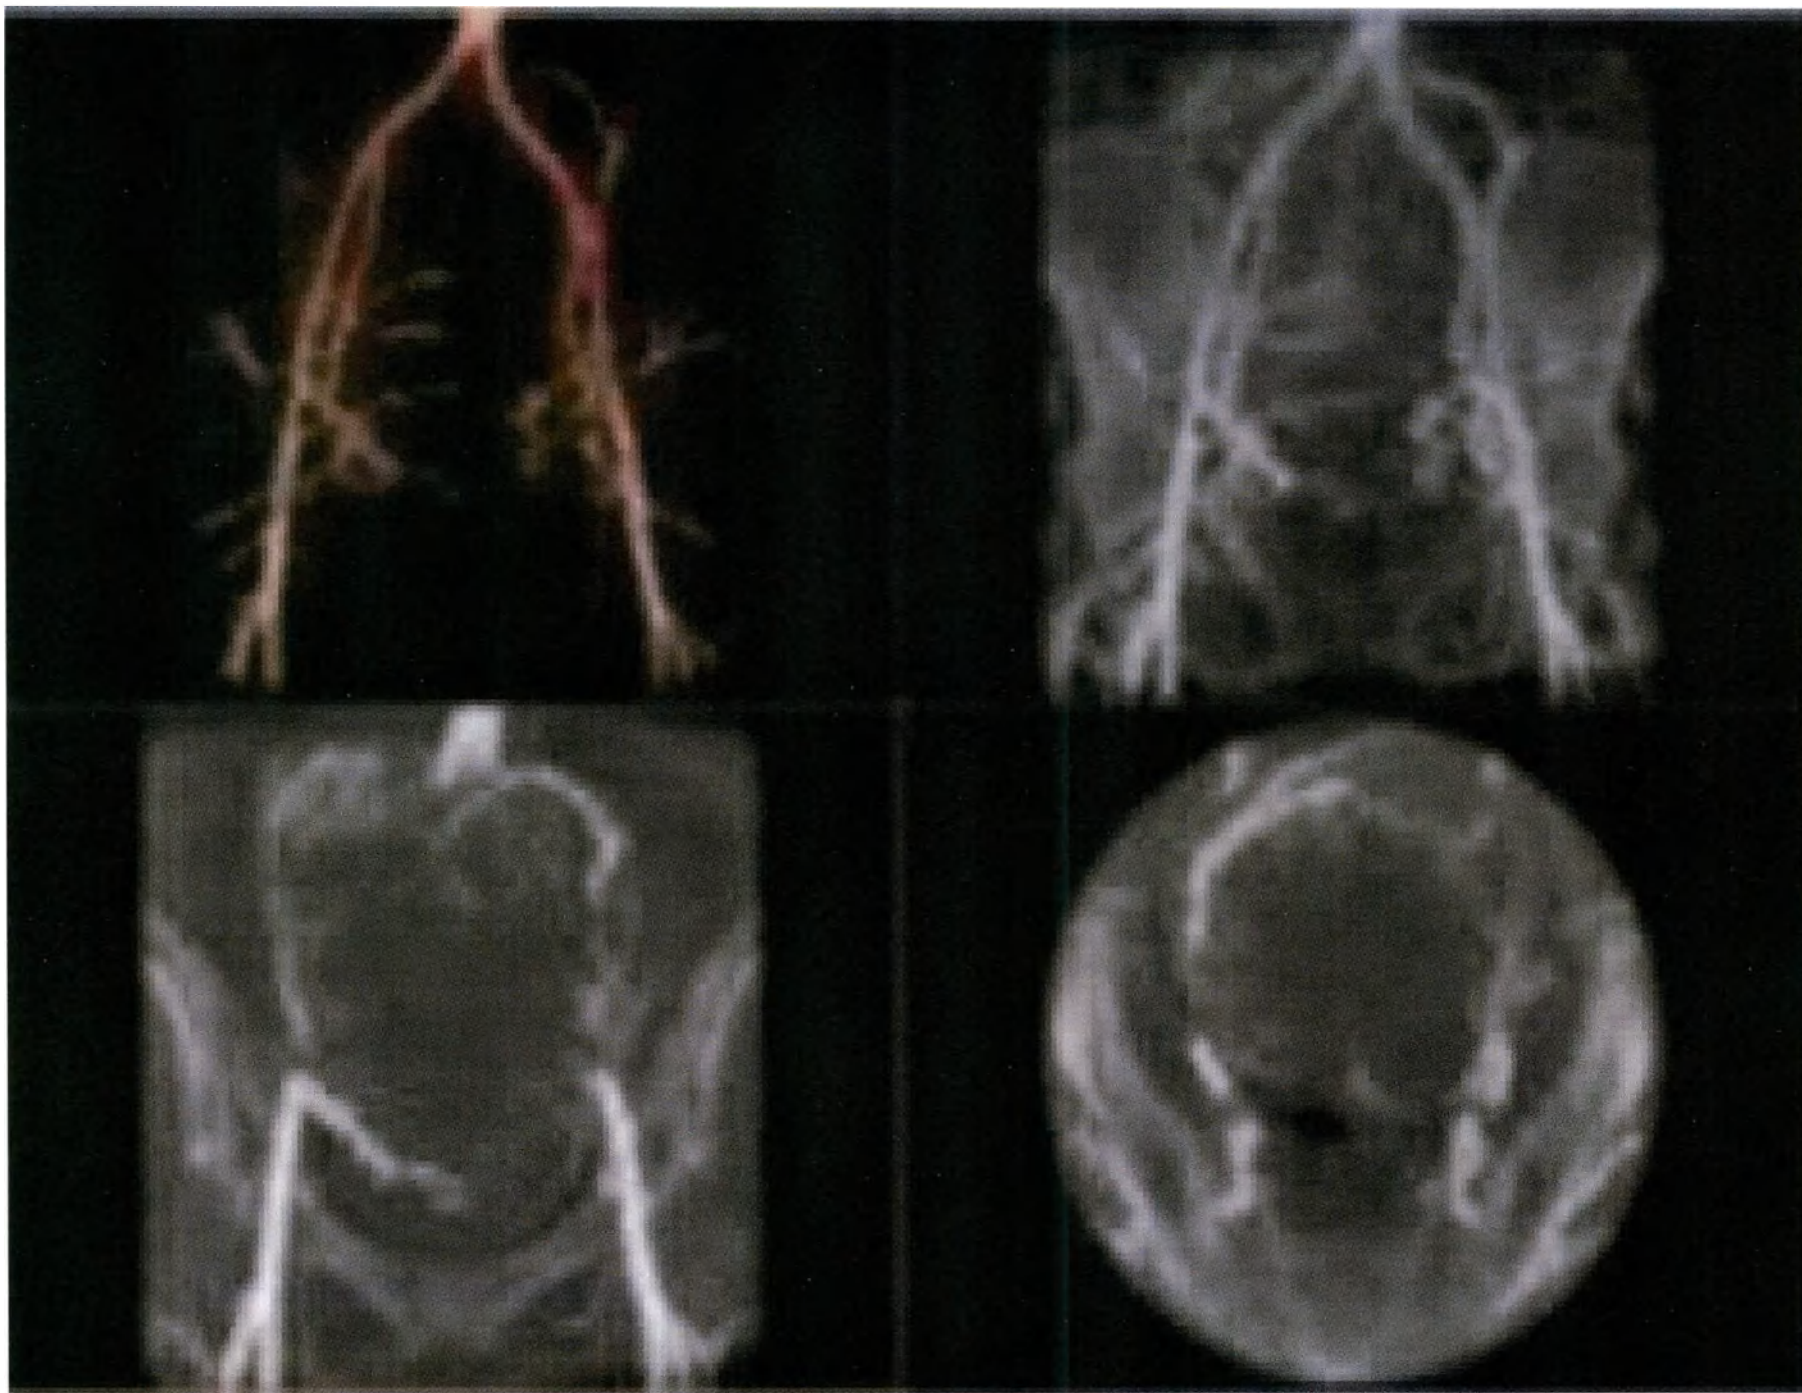


Рисунок 210. Конкурентная клиентская лицензия на запуск клинического приложения Volume Viewer Innova Digital

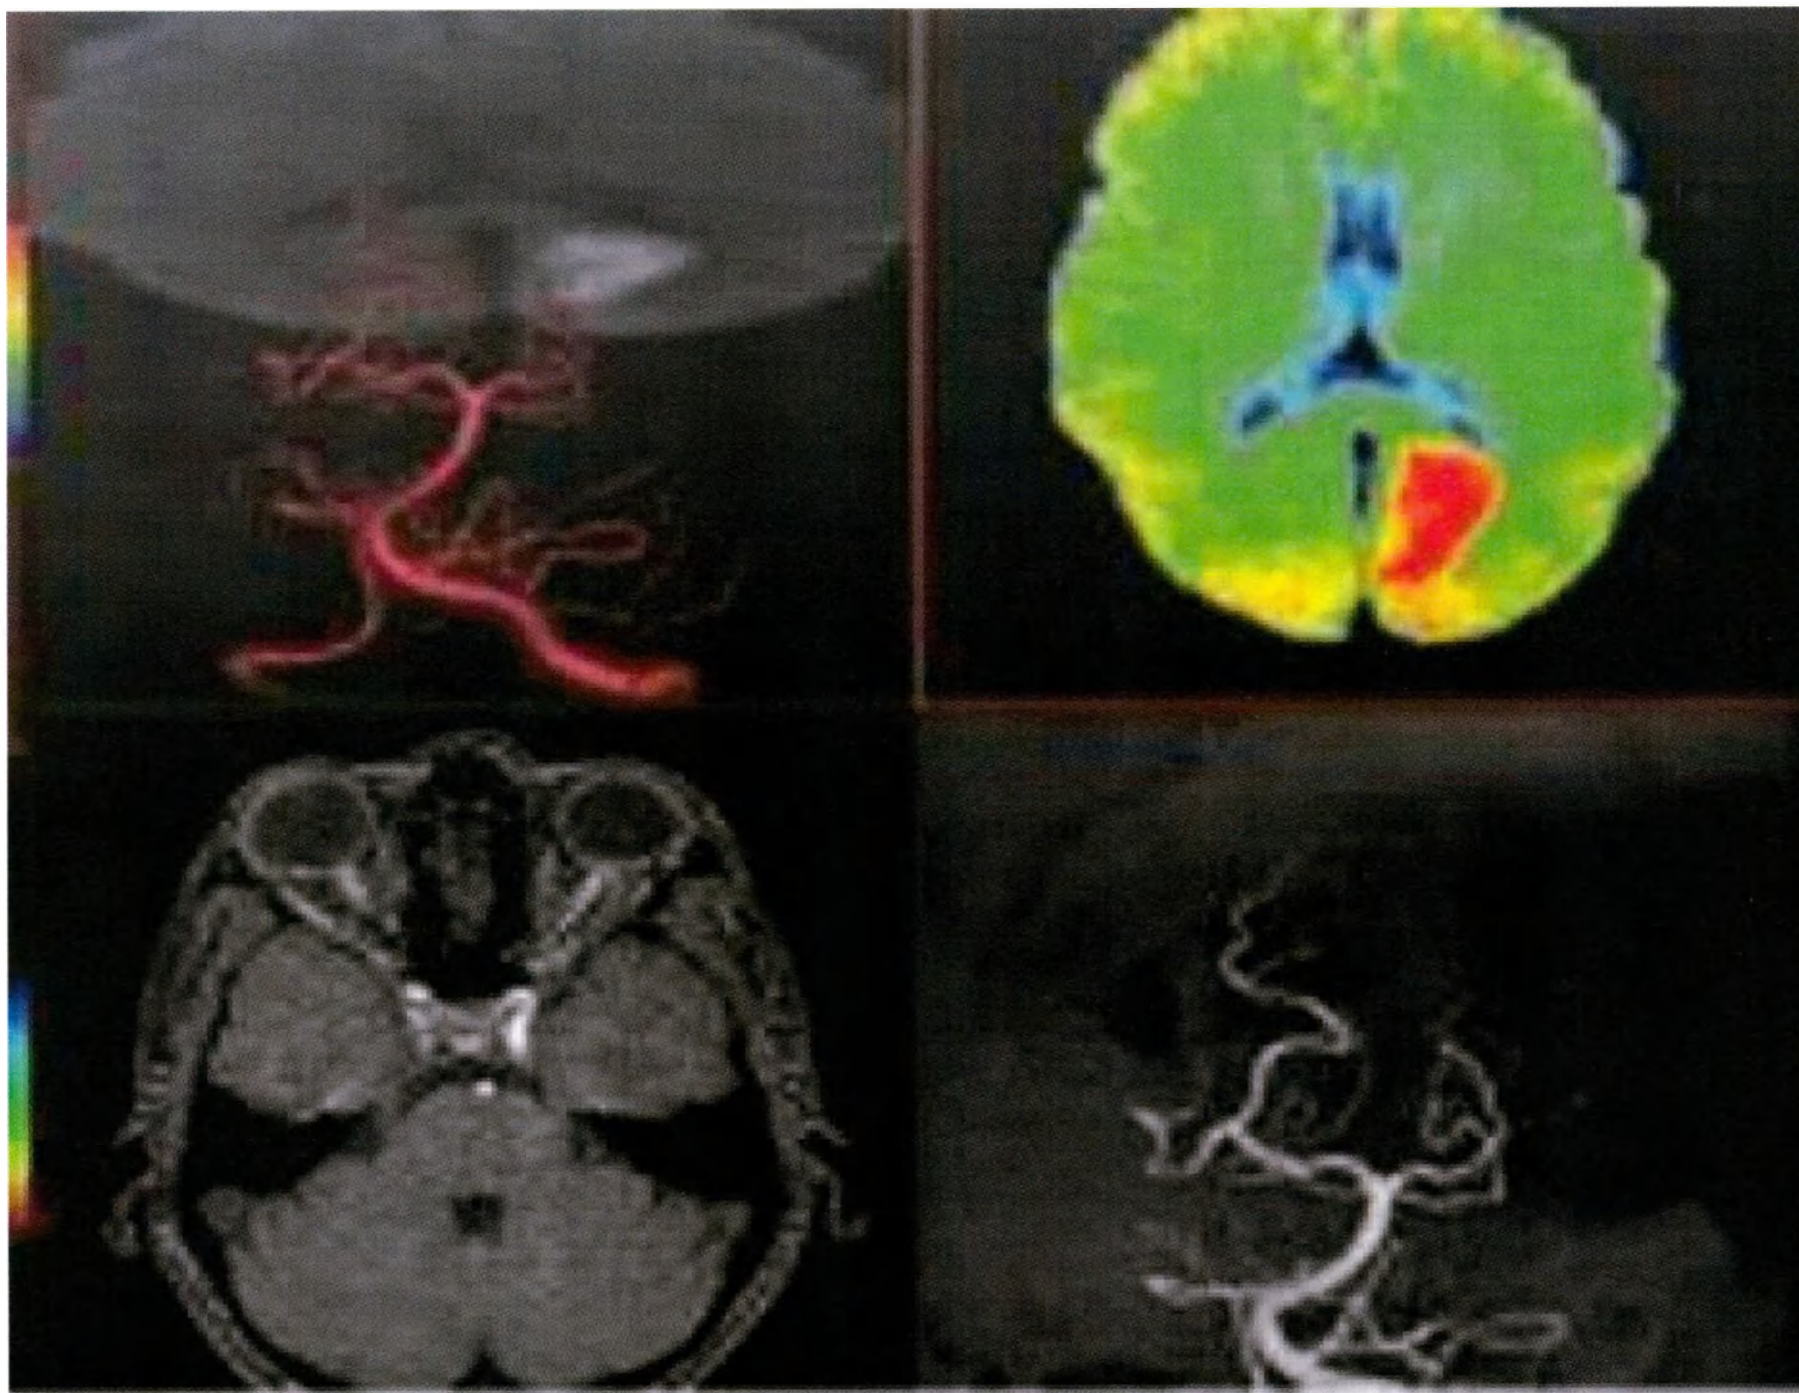


Рисунок 211. Конкурентная клиентская лицензия на запуск клинического приложения Integrated Registration Digital

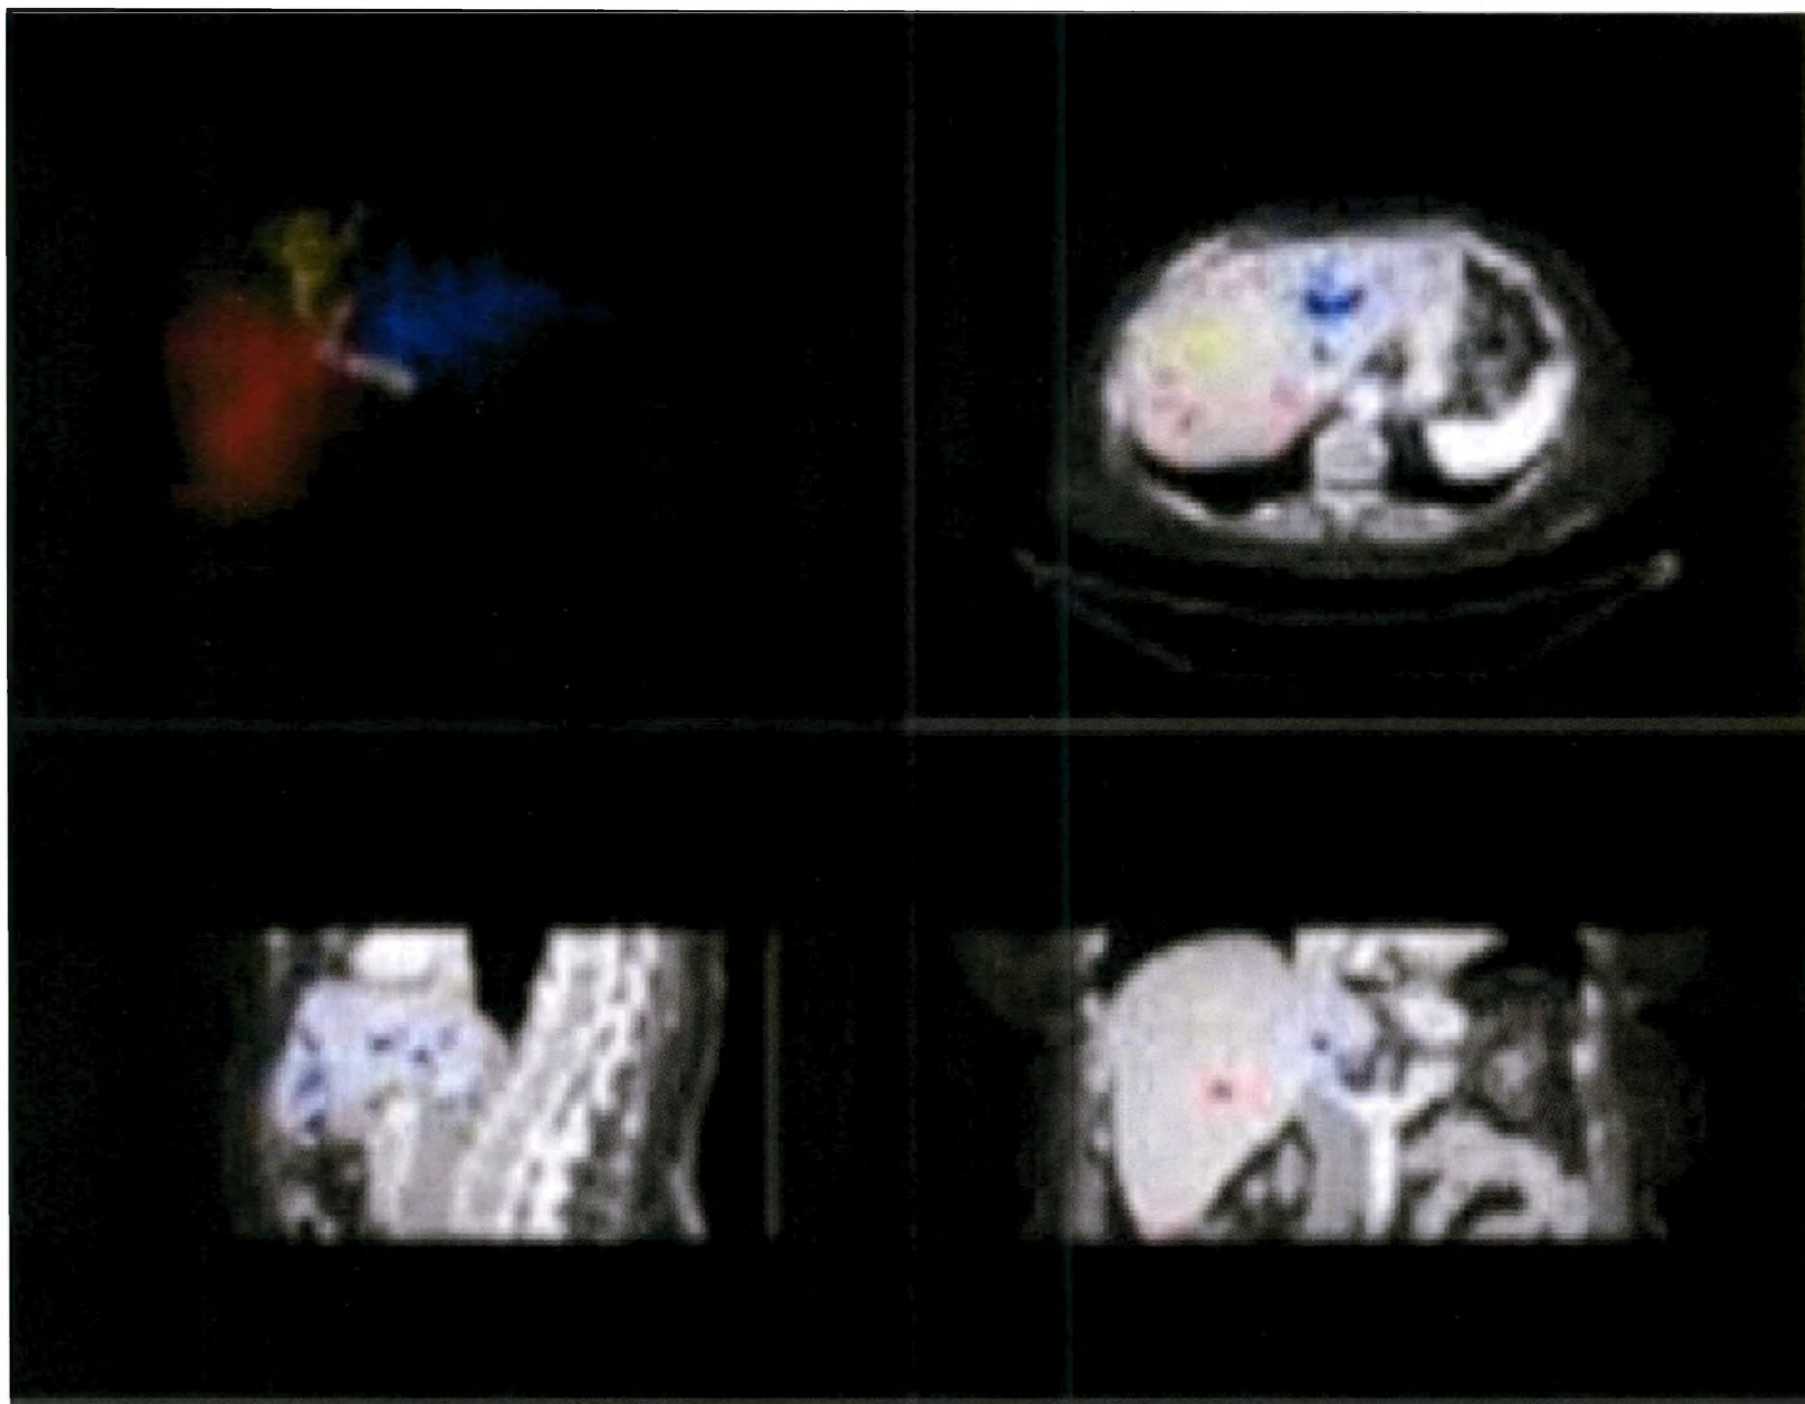


Рисунок 212. Конкурентная клиентская лицензия на запуск клинического приложения Hepatic VCAR Digital



Рисунок 213. Конкурентная клиентская лицензия на запуск клинического приложения Hepatic VCAR upgrade from previous version Digital

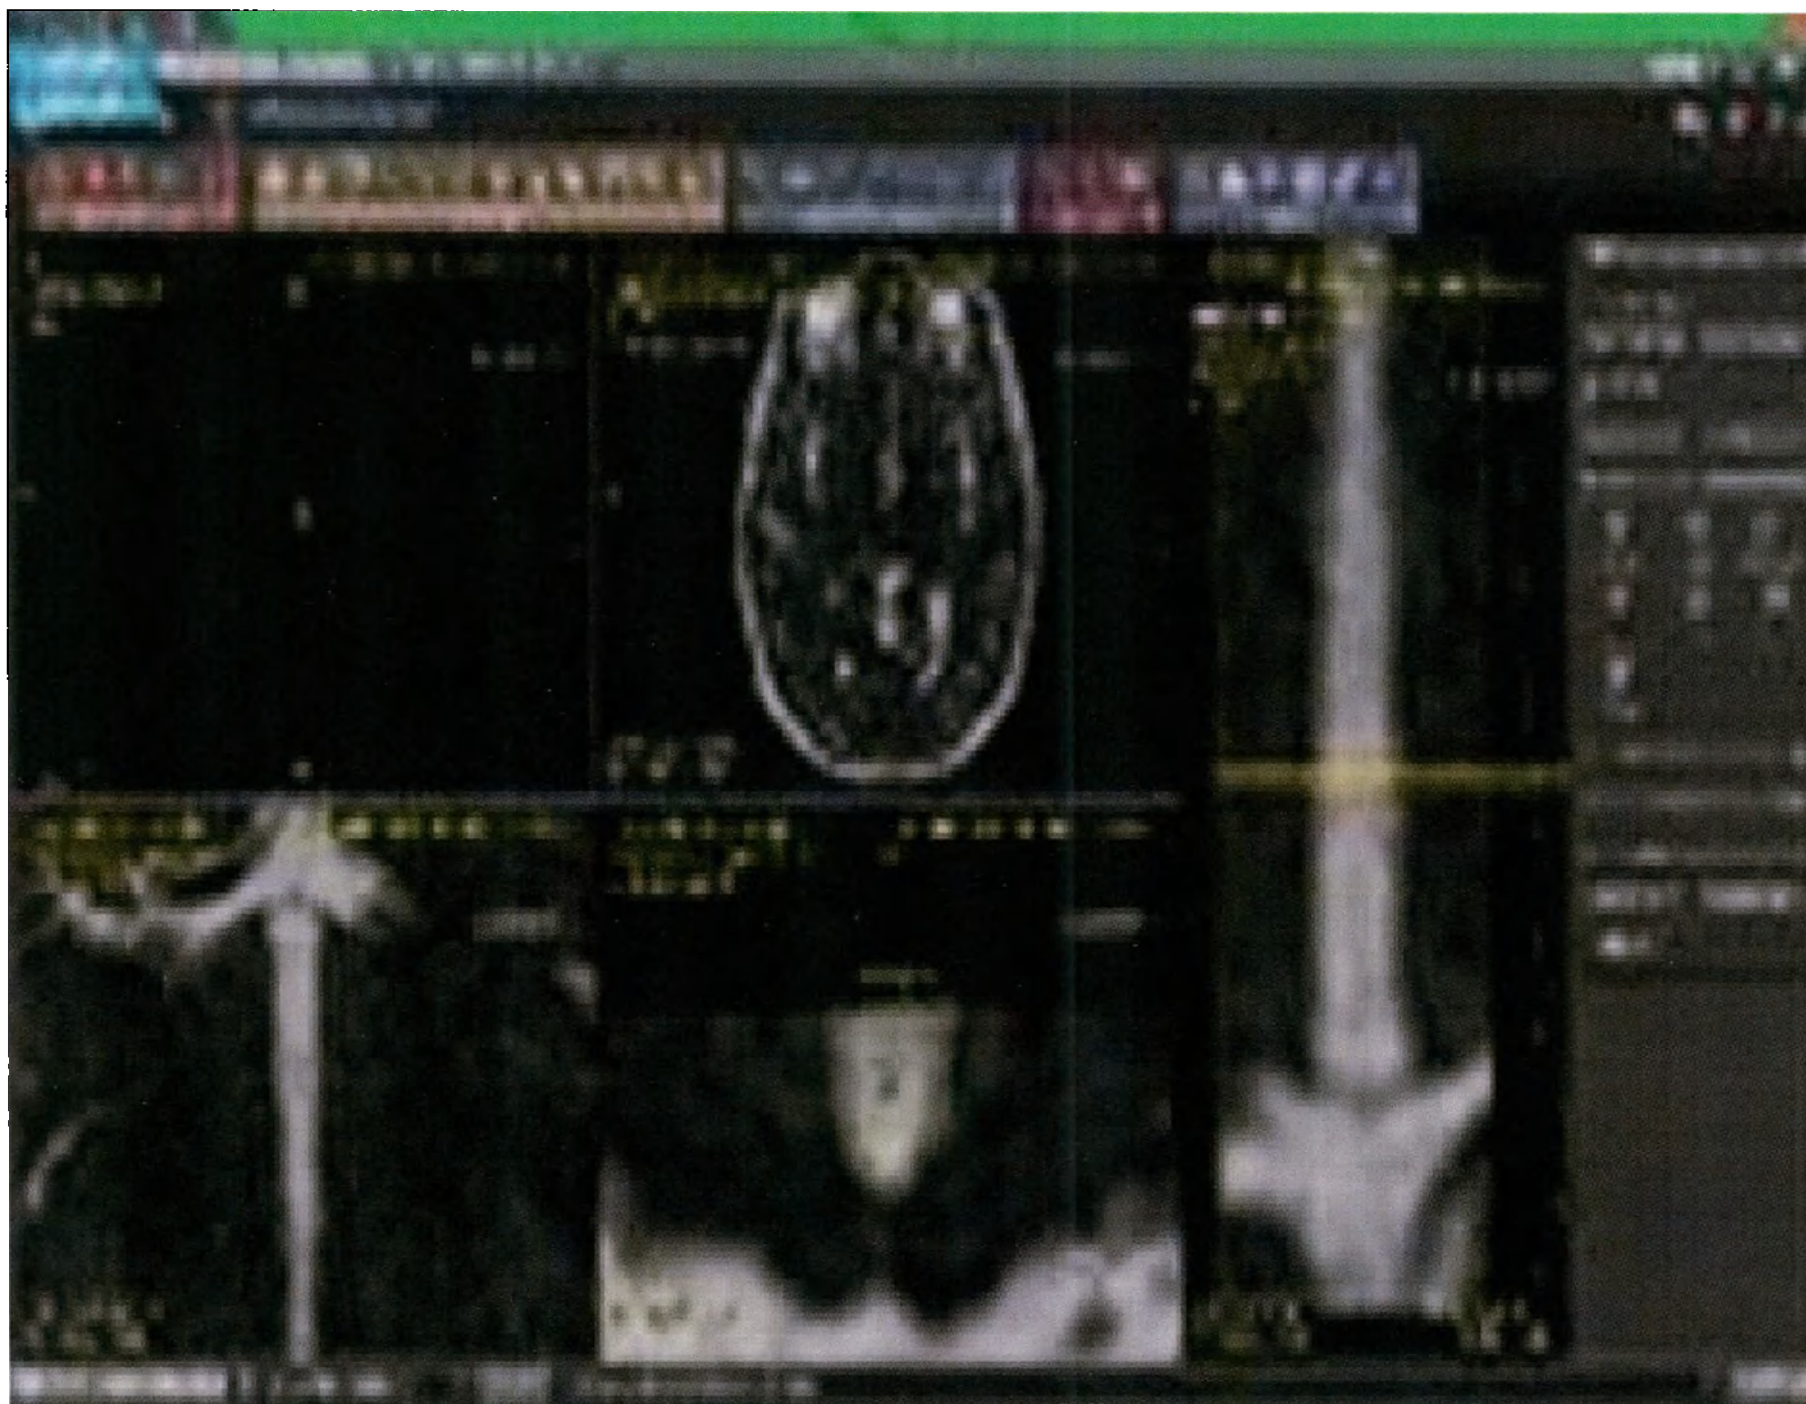


Рисунок 214. Конкурентная клиентская лицензия на запуск клинического приложения MR VessellQ Xpress Digital

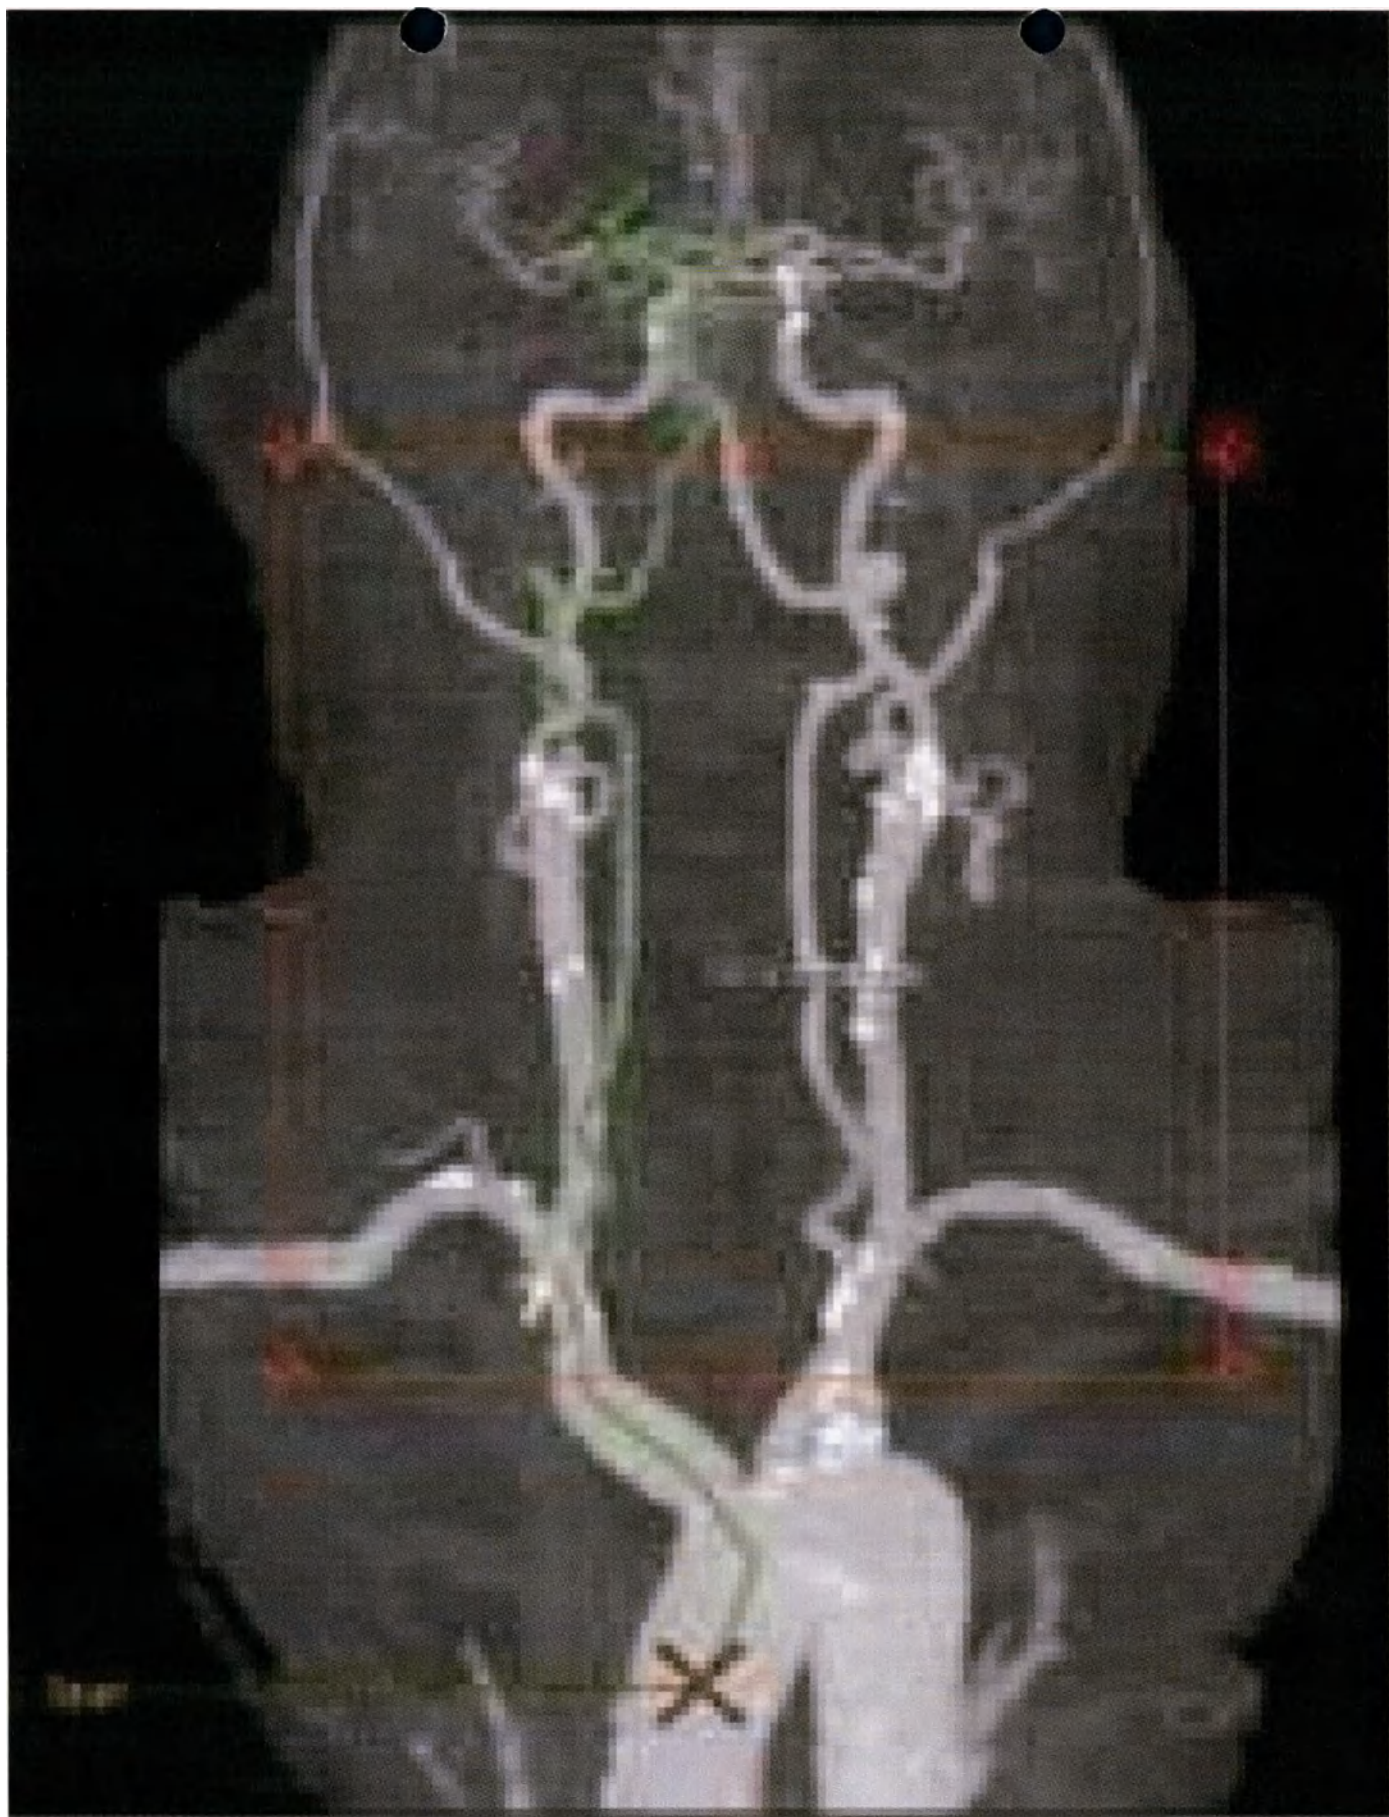


Рисунок 215. Конкурентная клиентская лицензия на запуск клинического приложения VessellQ Xpress Digital



Рисунок 216. Конкурентная клиентская лицензия на запуск клинического приложения Autobone Xpress Digital

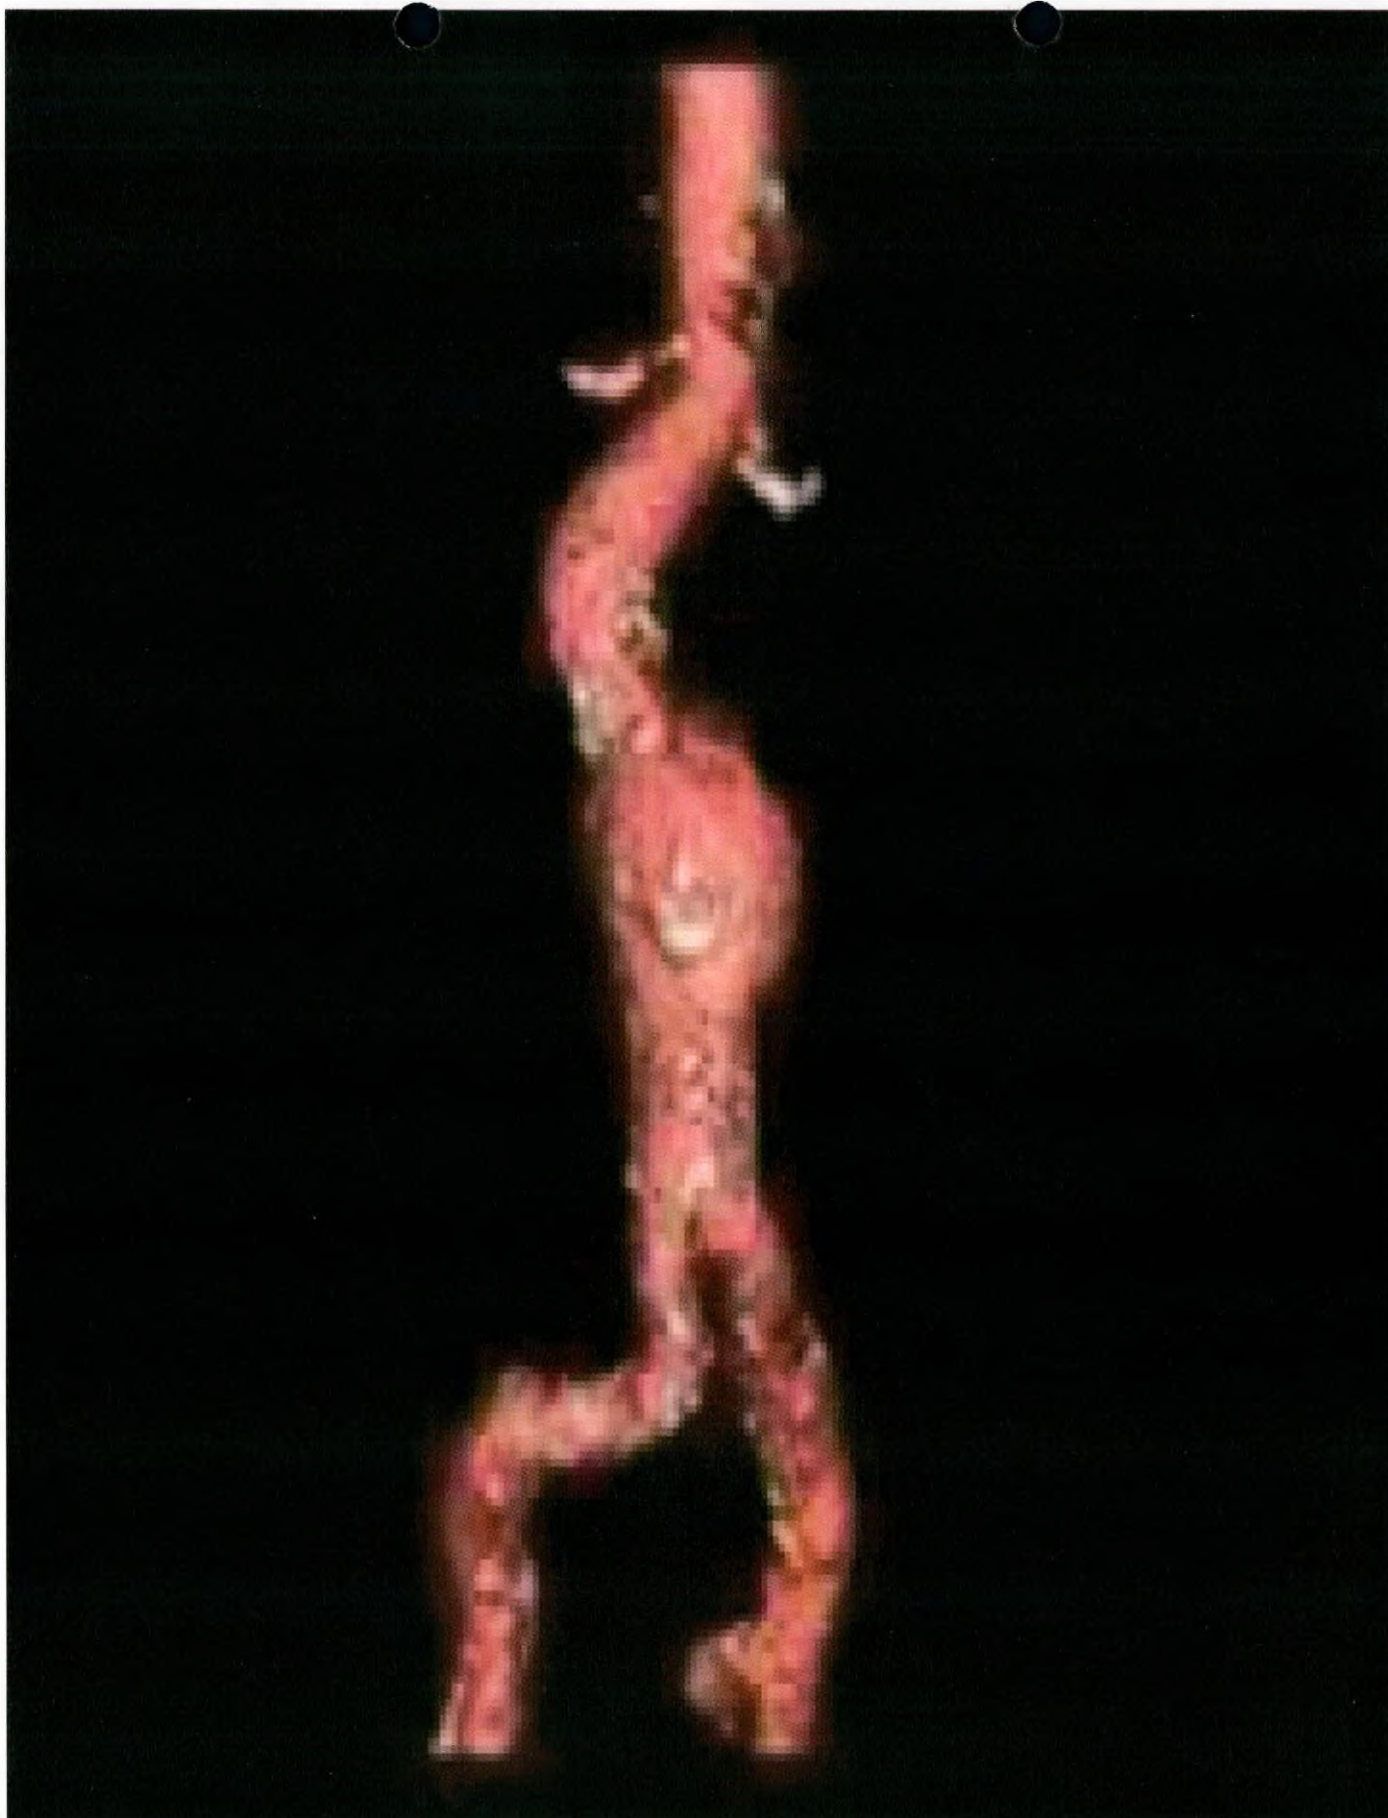


Рисунок 217. Конкурентная клиентская лицензия на запуск клинического приложения FlightPlan for EVAR CT Digital

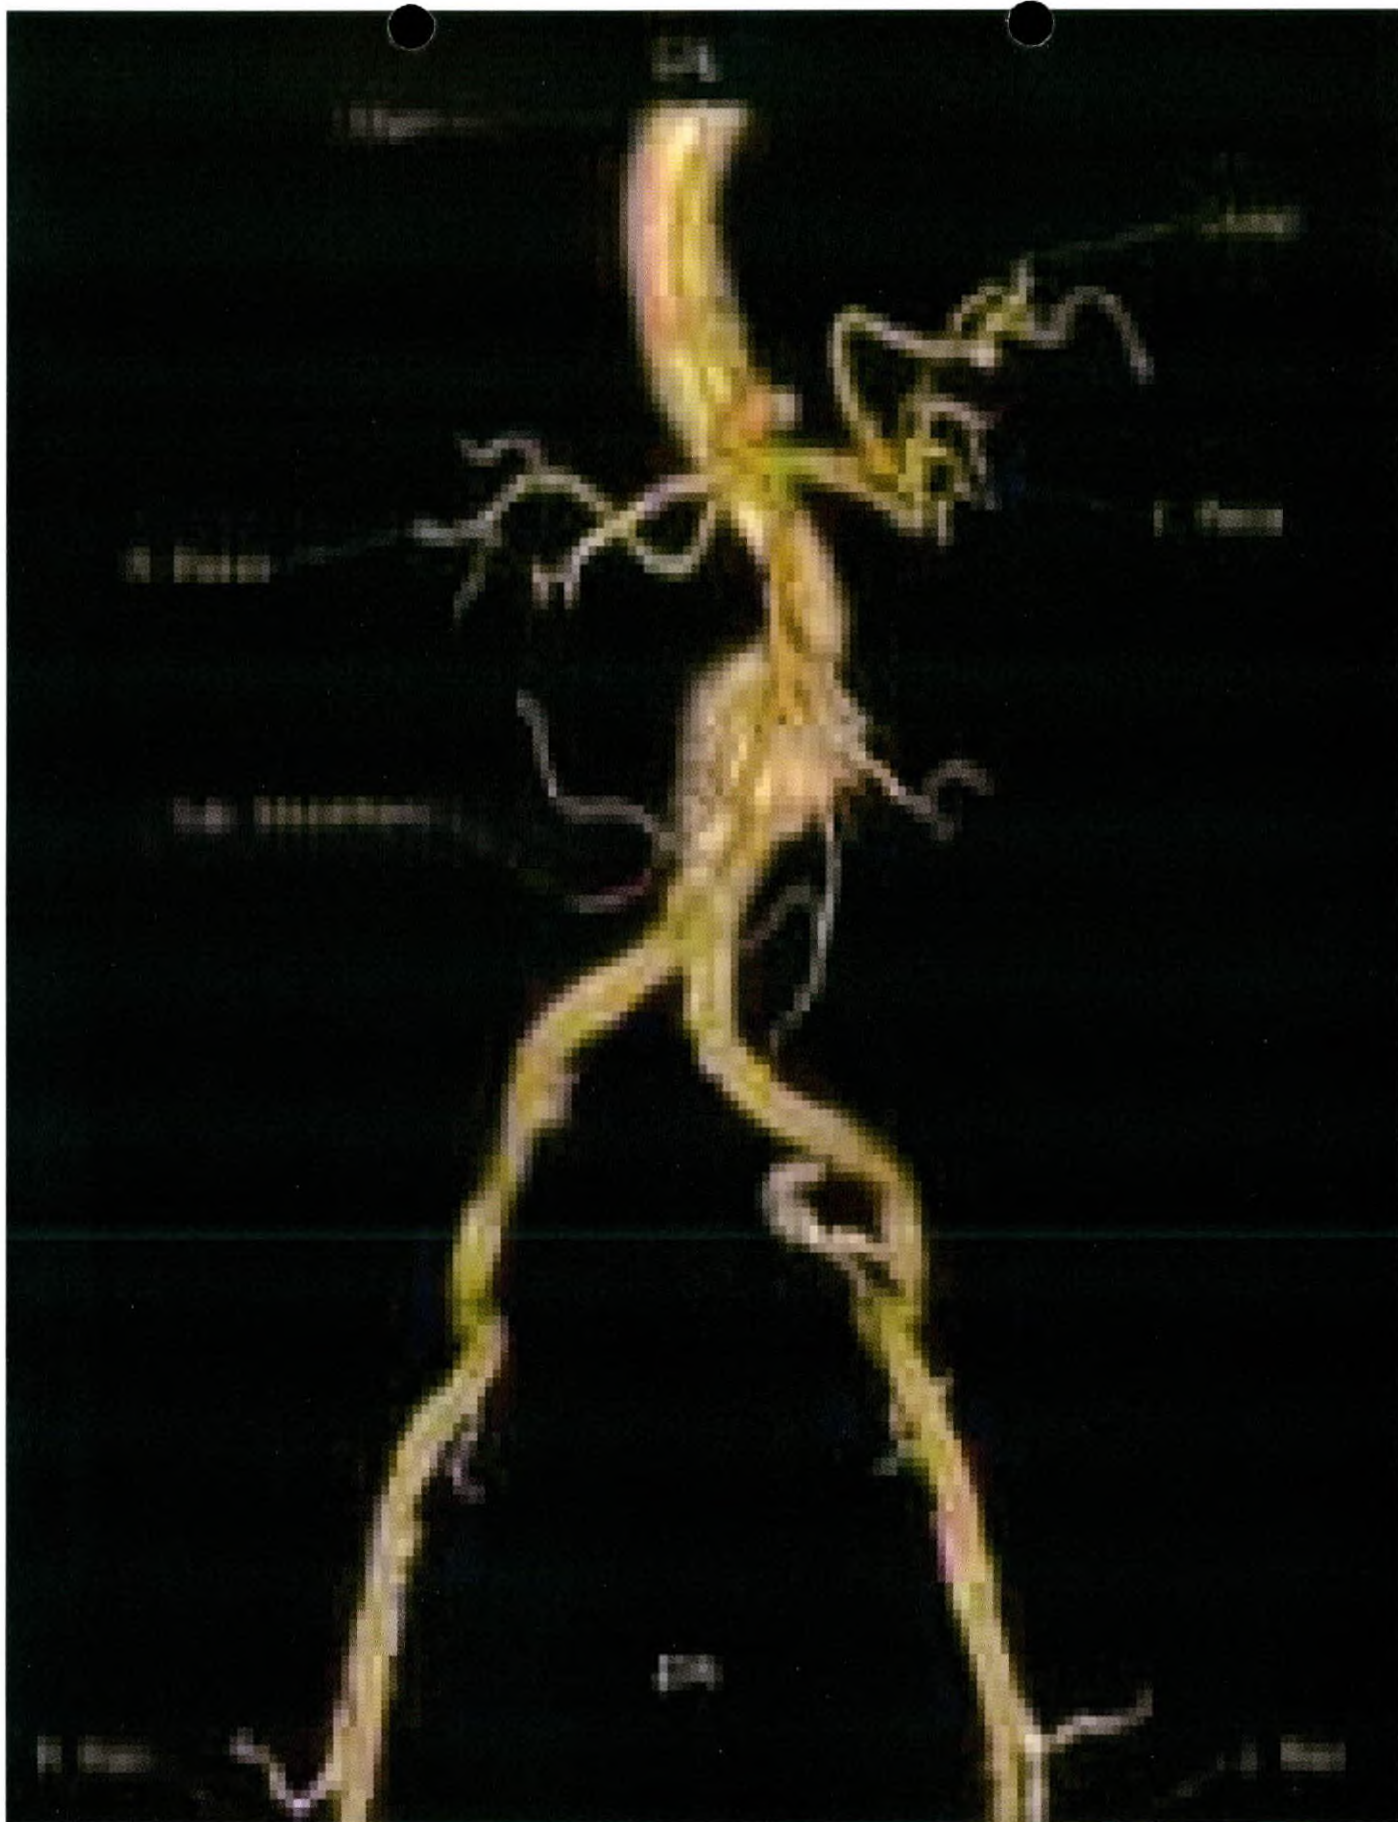


Рисунок 218. Конкурентная клиентская лицензия на запуск клинического приложения FlightPlan for EVAR MR Digital

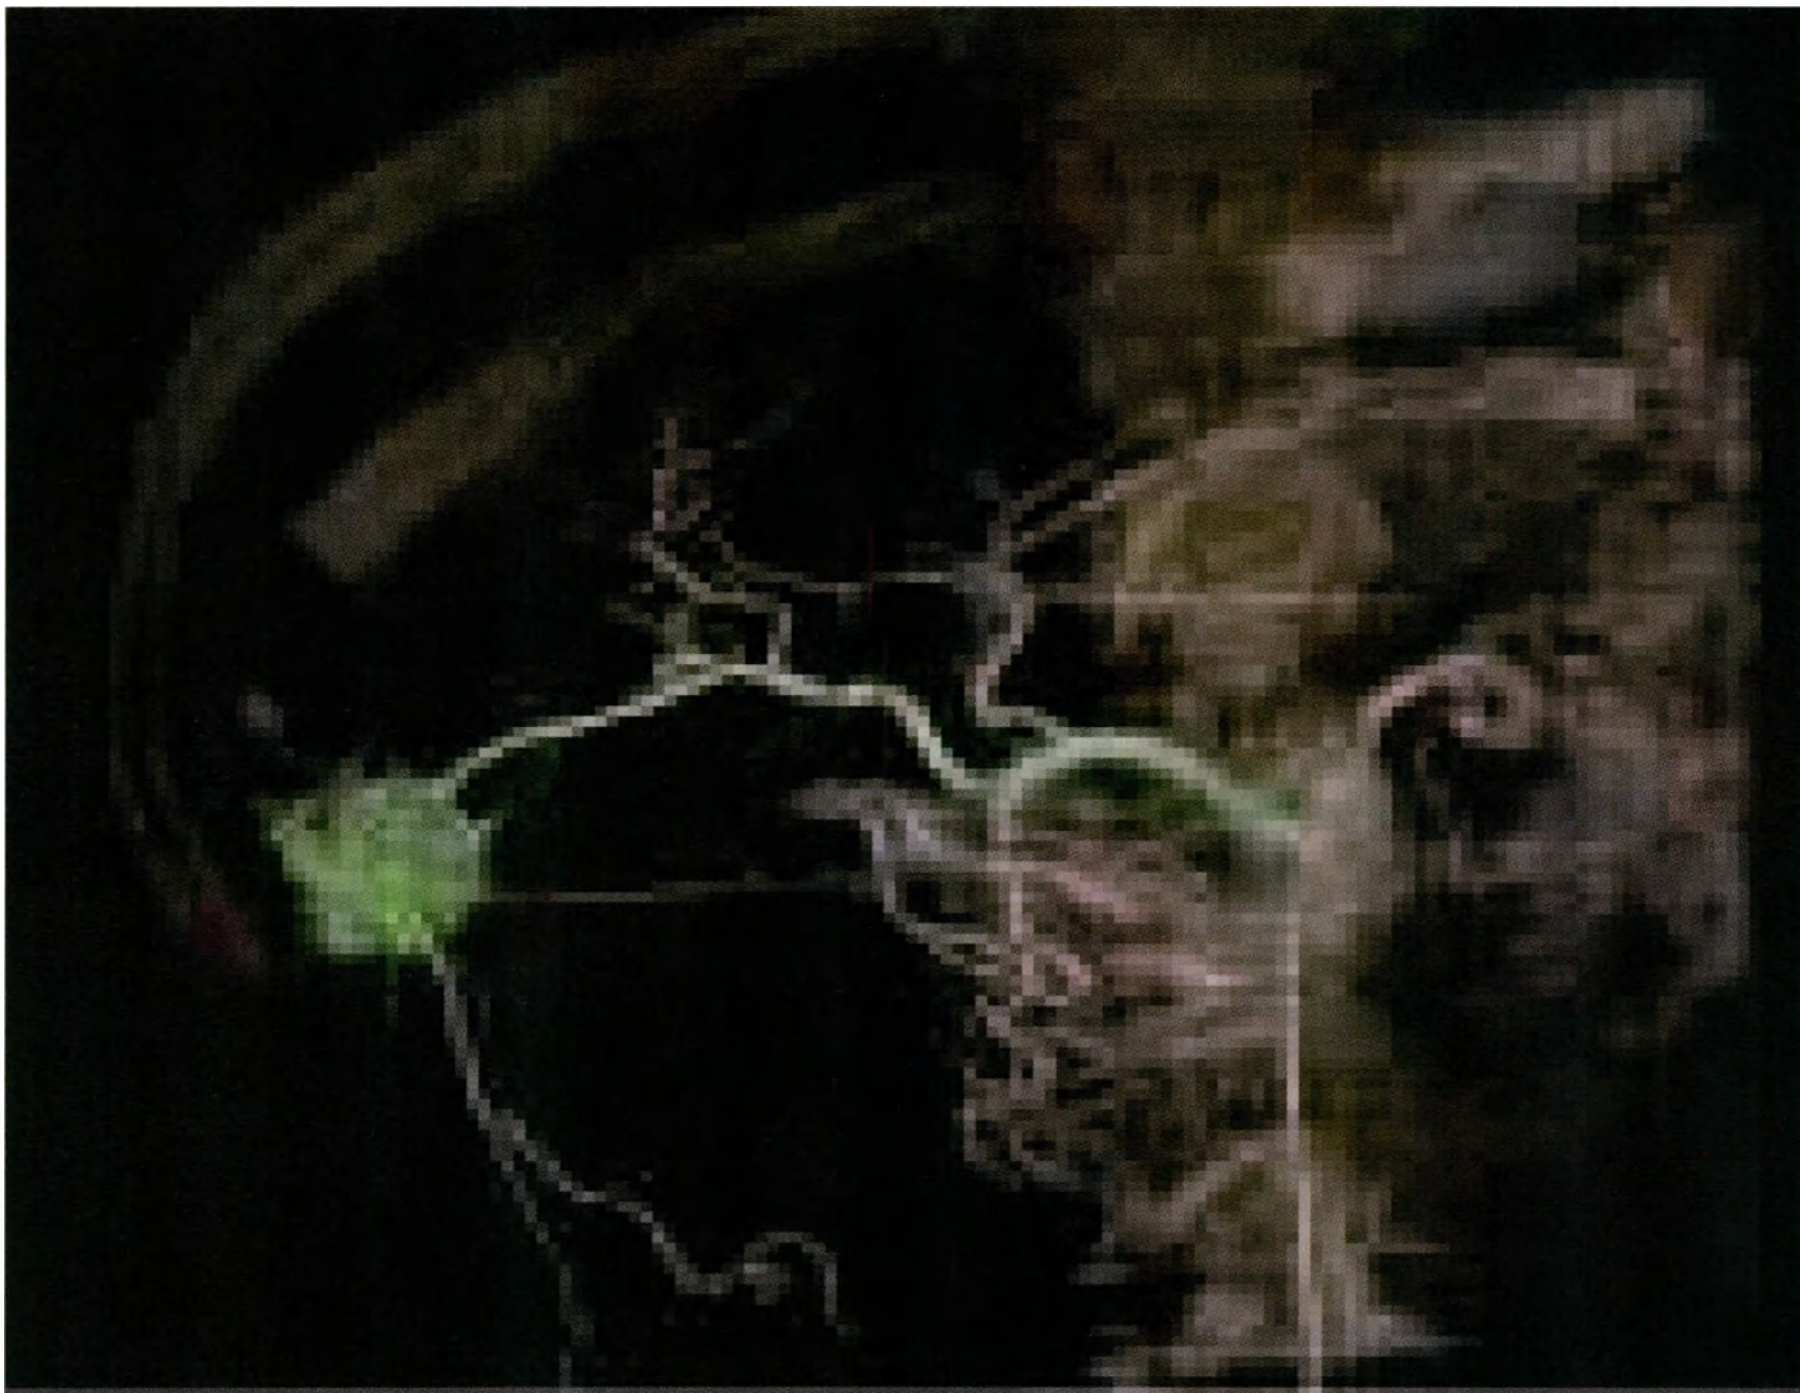


Рисунок 219. Конкурентная клиентская лицензия на запуск клинического приложения FlightPlan for Liver Digital



Рисунок 220. Конкурентная клиентская лицензия на запуск клинического приложения FlightPlan for Embolization Digital

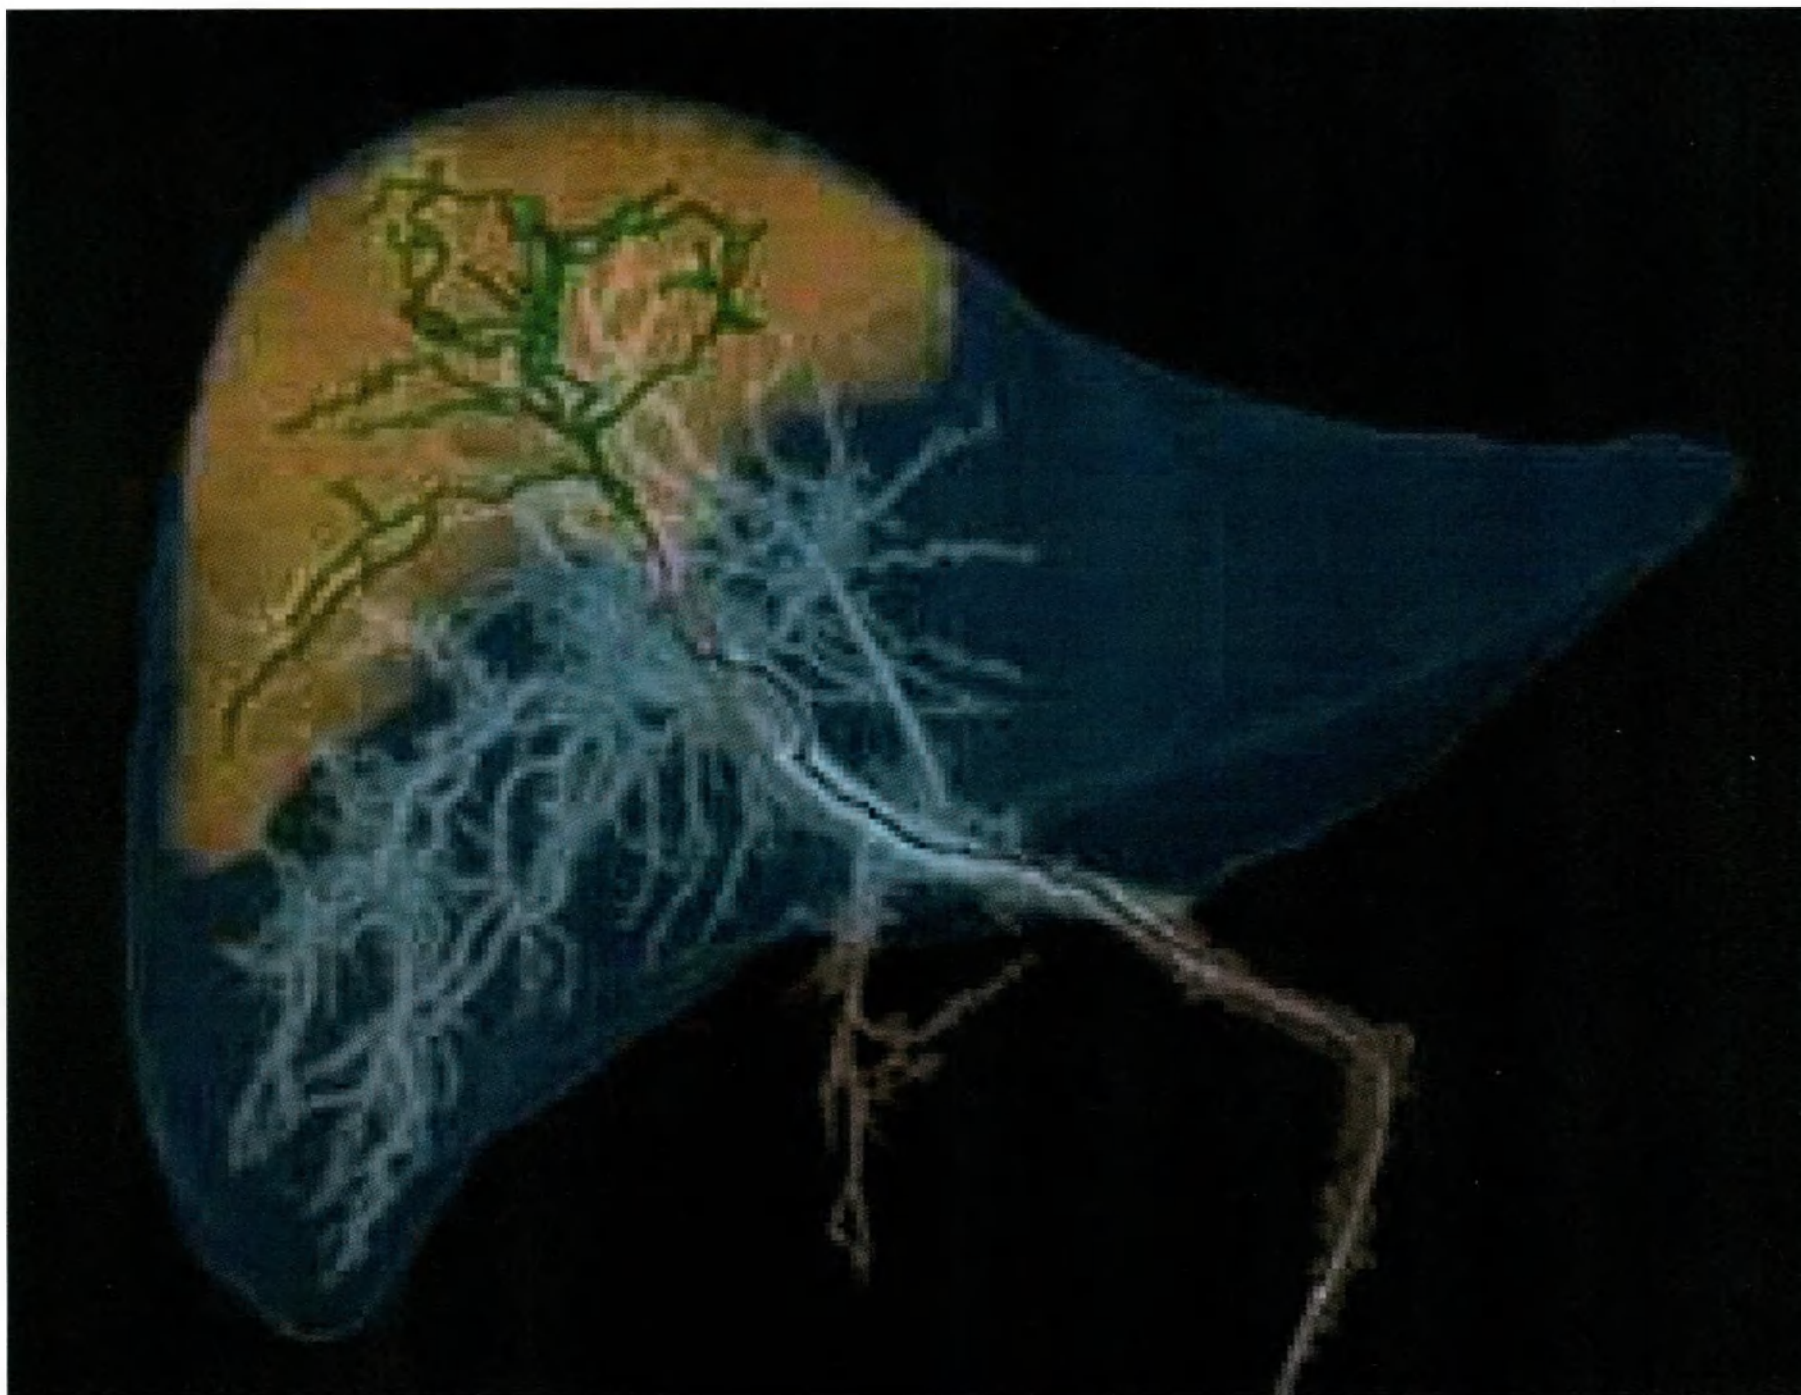


Рисунок 221. Конкурентная клиентская лицензия на запуск клинического приложения Liver Parenchyma digital

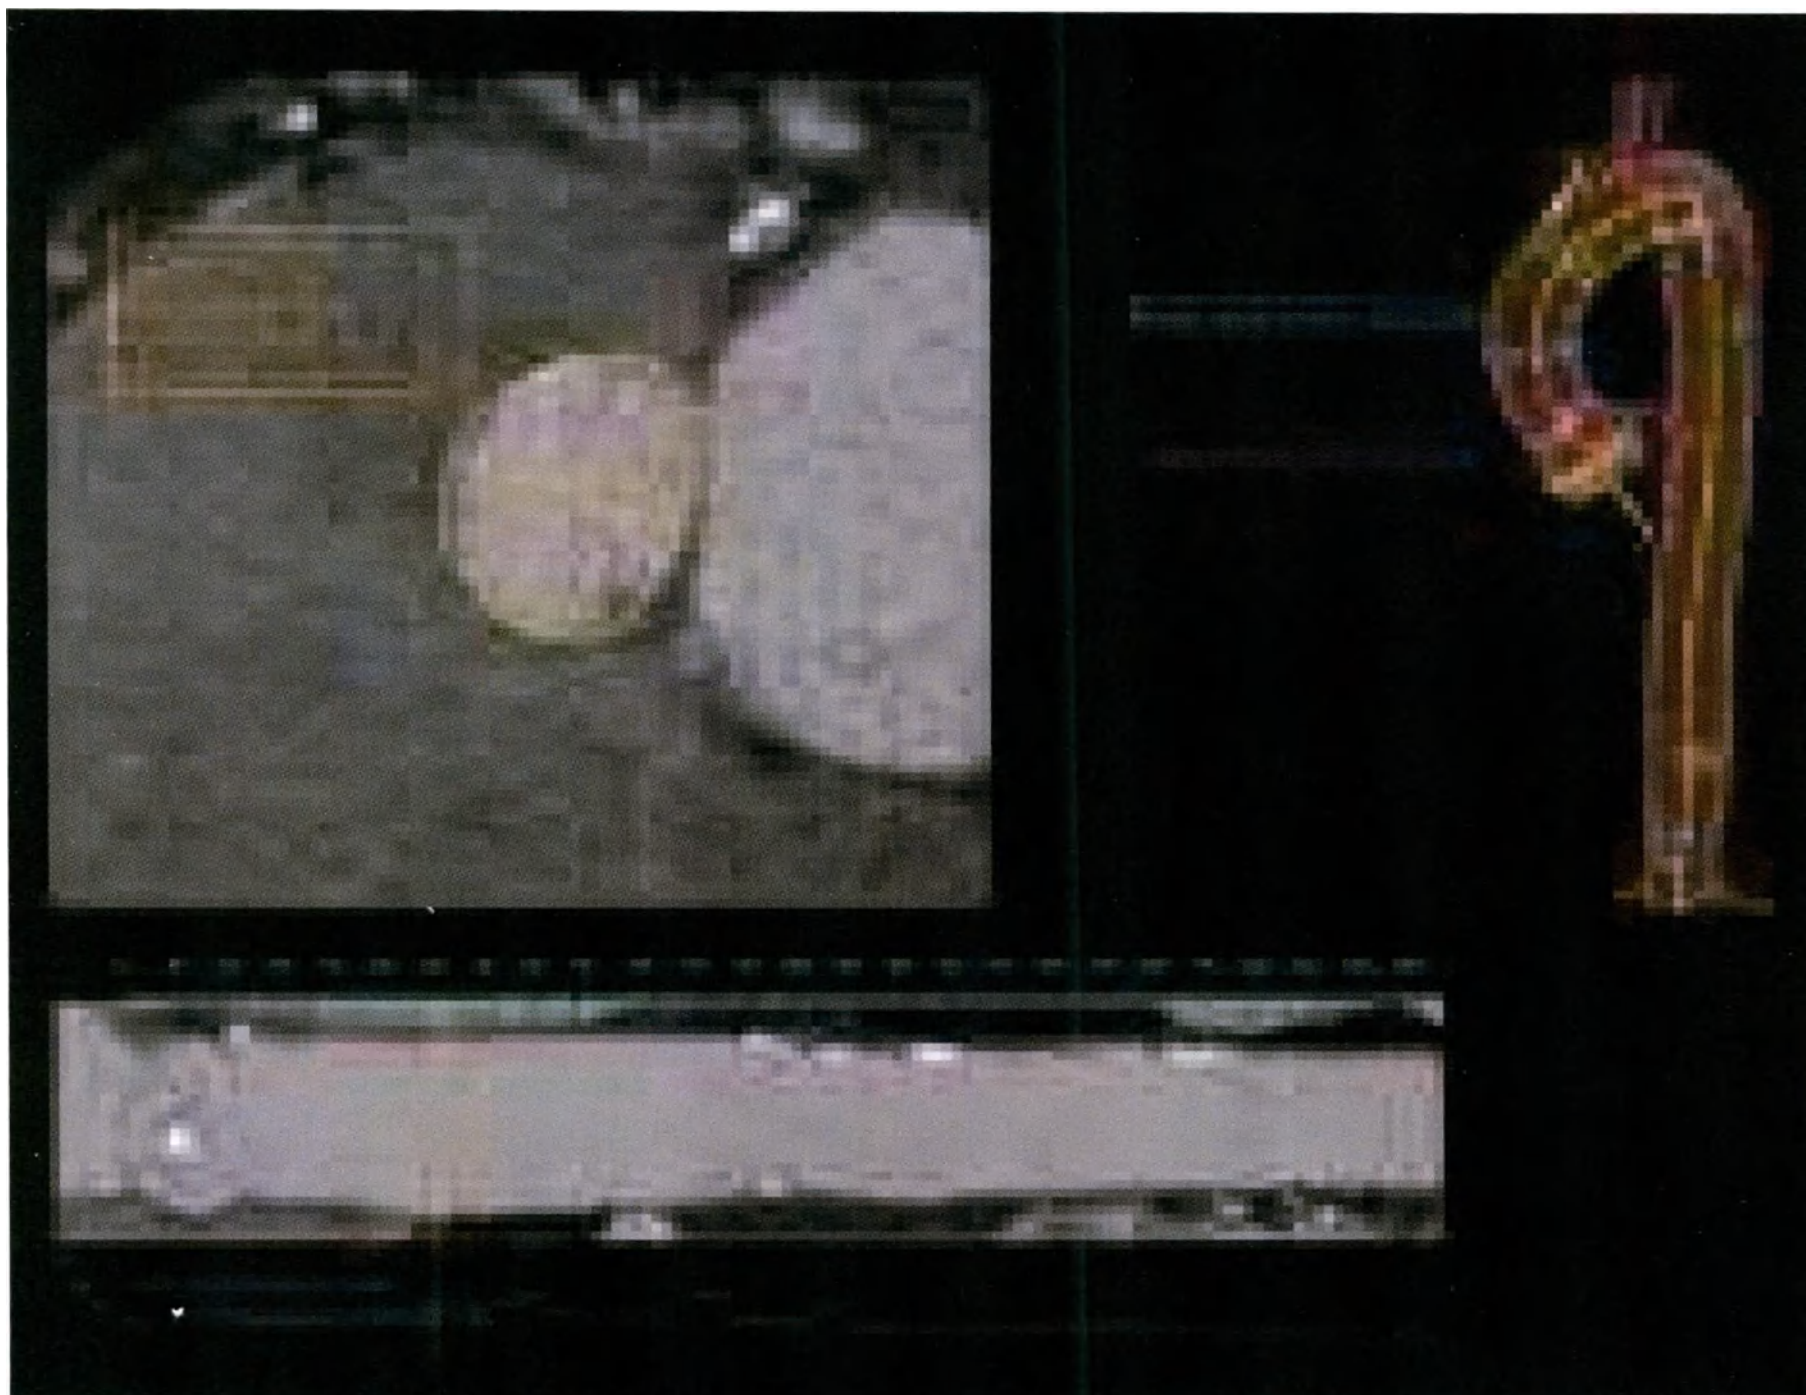


Рисунок 222. Конкурентная клиентская лицензия на запуск клинического приложения TAVI Analysis Digital



Рисунок 223. Конкурентная клиентская лицензия на запуск клинического приложения TAVI Analysis upgrade from previous version Digital

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 113

_____ листах

