

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «С-Инструментс Медикал»
Д.В. Соколов



(подпись)

«26» сентября 2023 г.

Дополнение
к файлу фотографических изображений медицинского изделия

Аппарат искусственной вентиляции легких серии Vivo,
варианты исполнения Vivo 1, Vivo 2, Vivo 3.

Маркировка потокозависимых элементов и доступных оператору отверстий аппаратов искусственной вентиляции легких серии Vivo, вариантов исполнения Vivo 1, Vivo 2, Vivo 3 (одинаково для всех вариантов исполнений).










Фотографические изображения маркировки составных частей в потребительской упаковке (одинаково для всех вариантов исполнений).

2. Крышка обходная, воздушная.

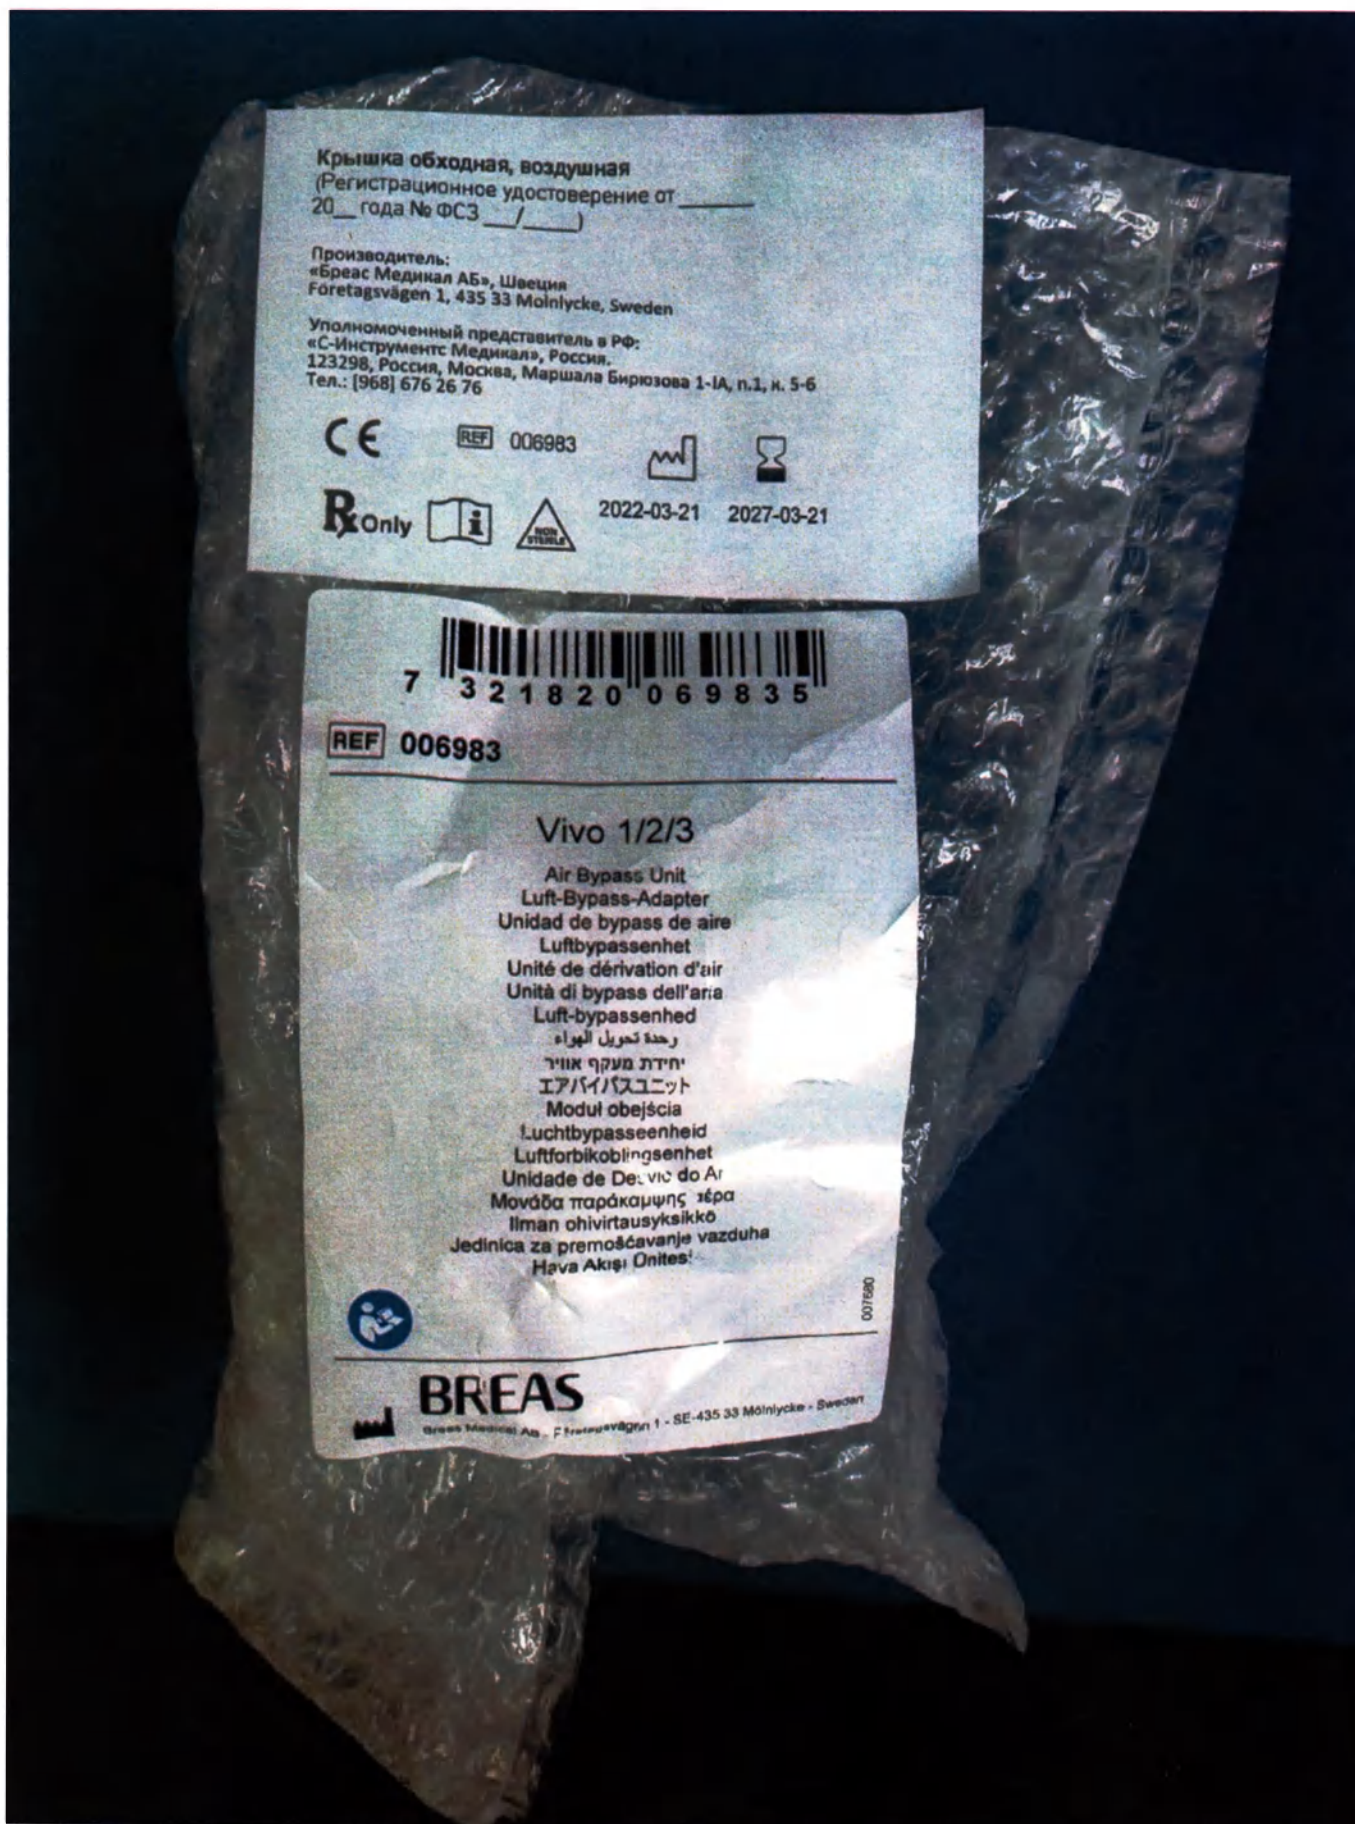


3. Держатель фильтров




4. Фильтр воздухозаборного отверстия, грубой очистки




5. Фильтр воздухозаборного отверстия, тонкой очистки

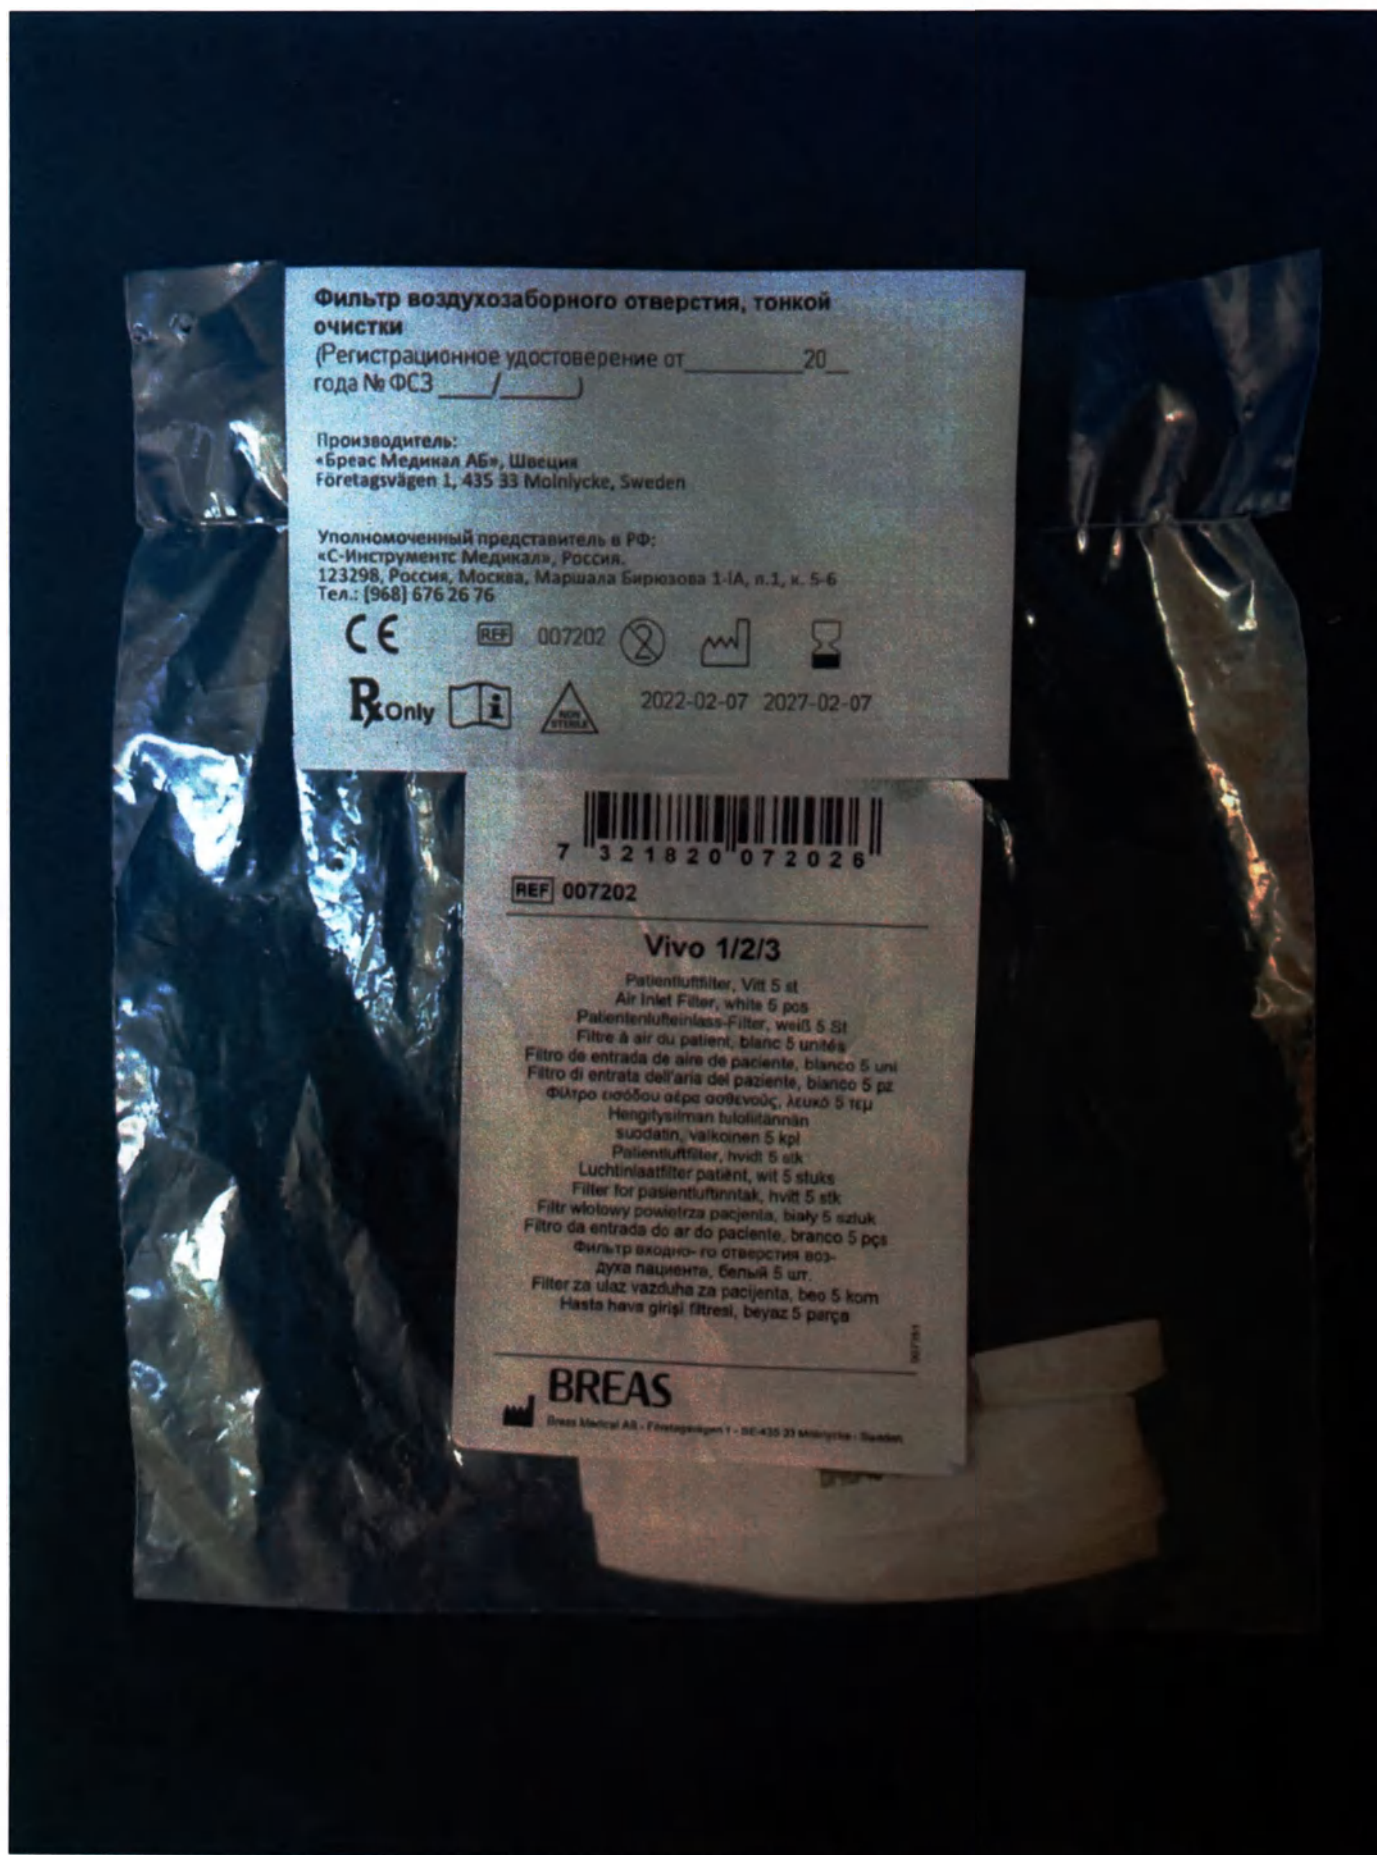

6. Адаптер питания AC/DC.

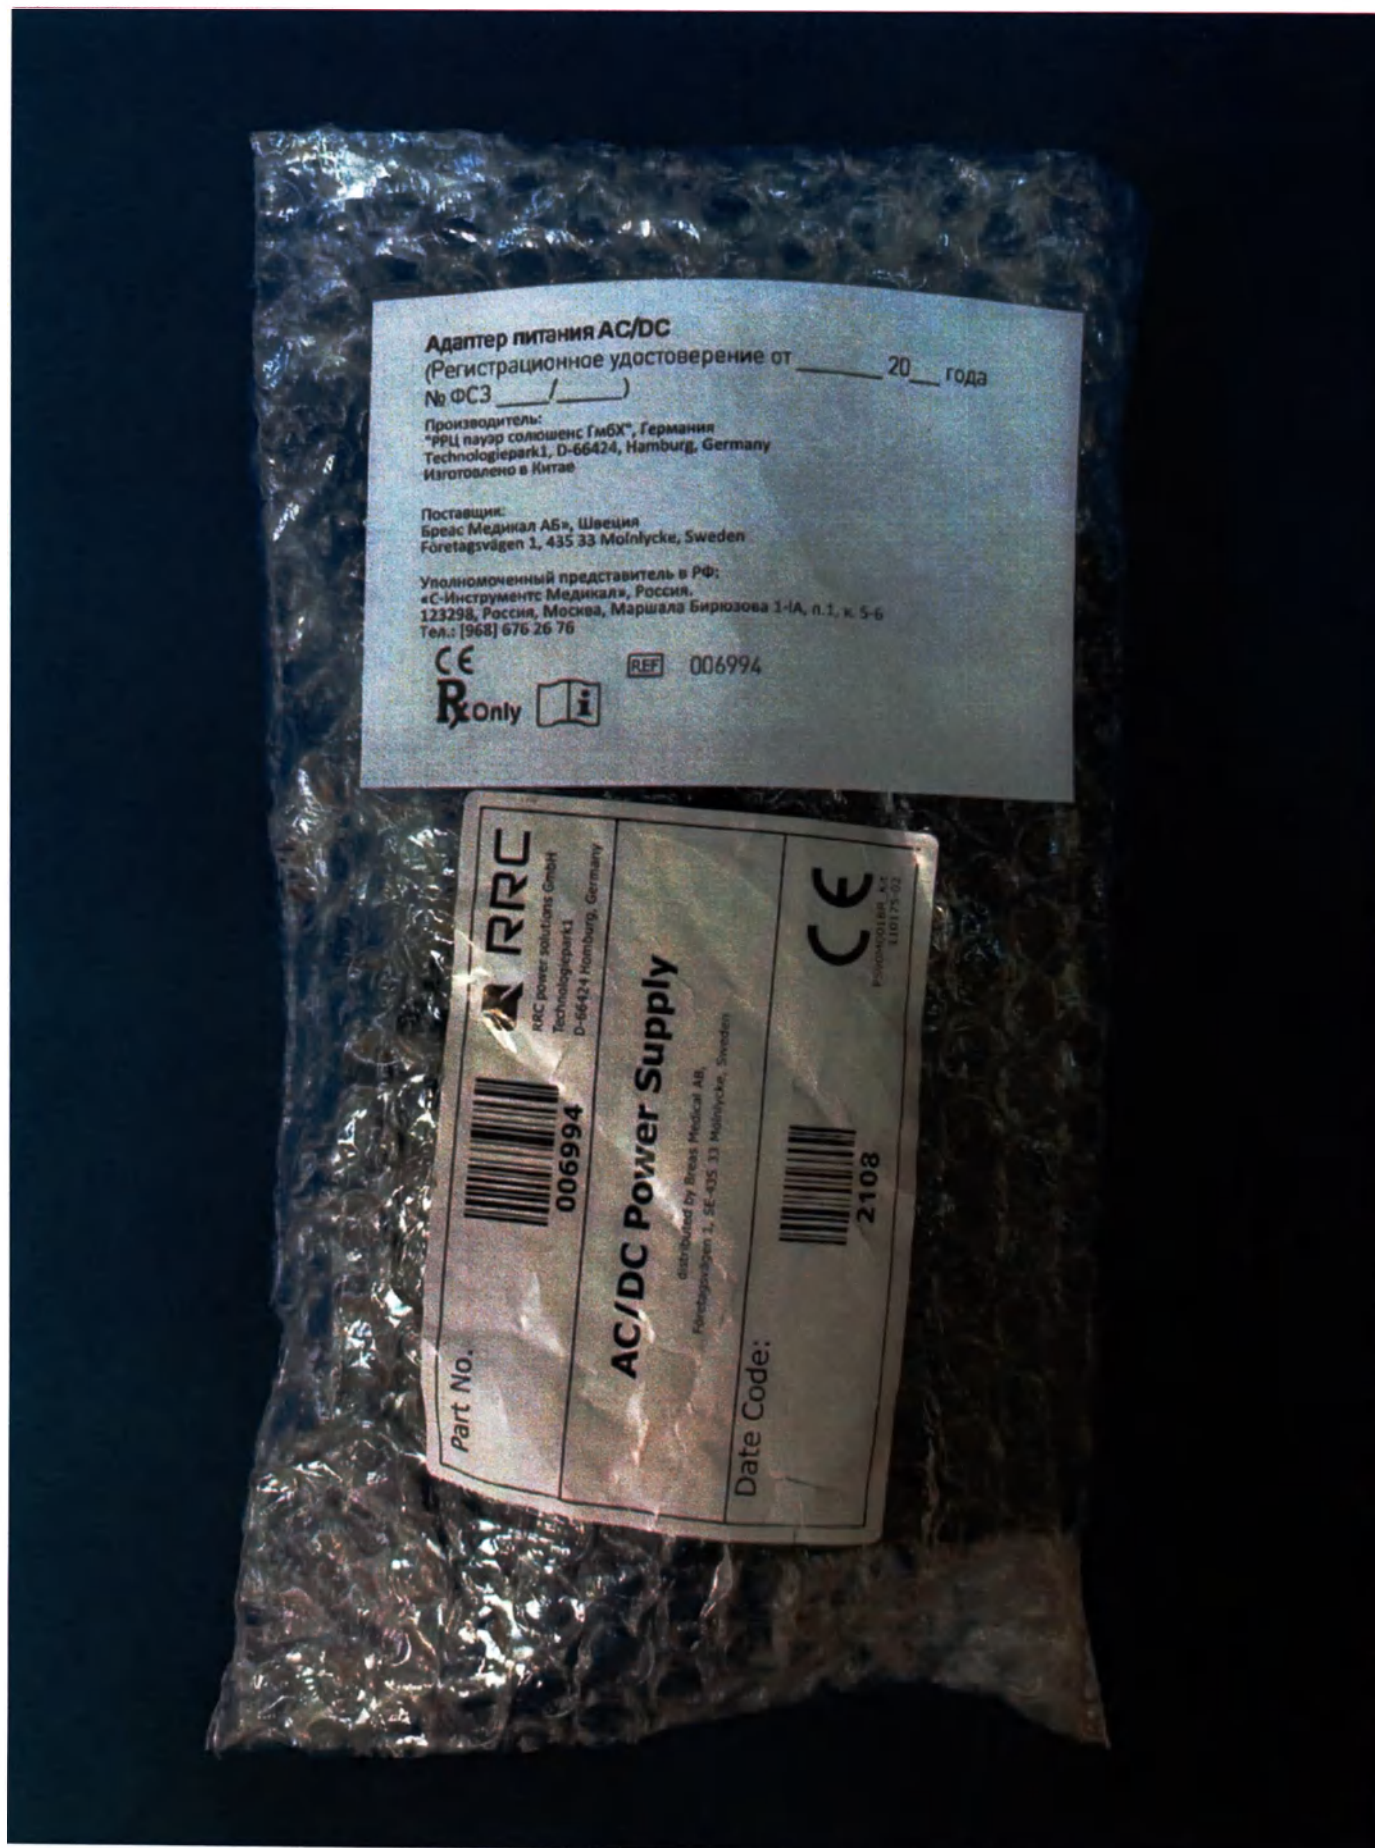

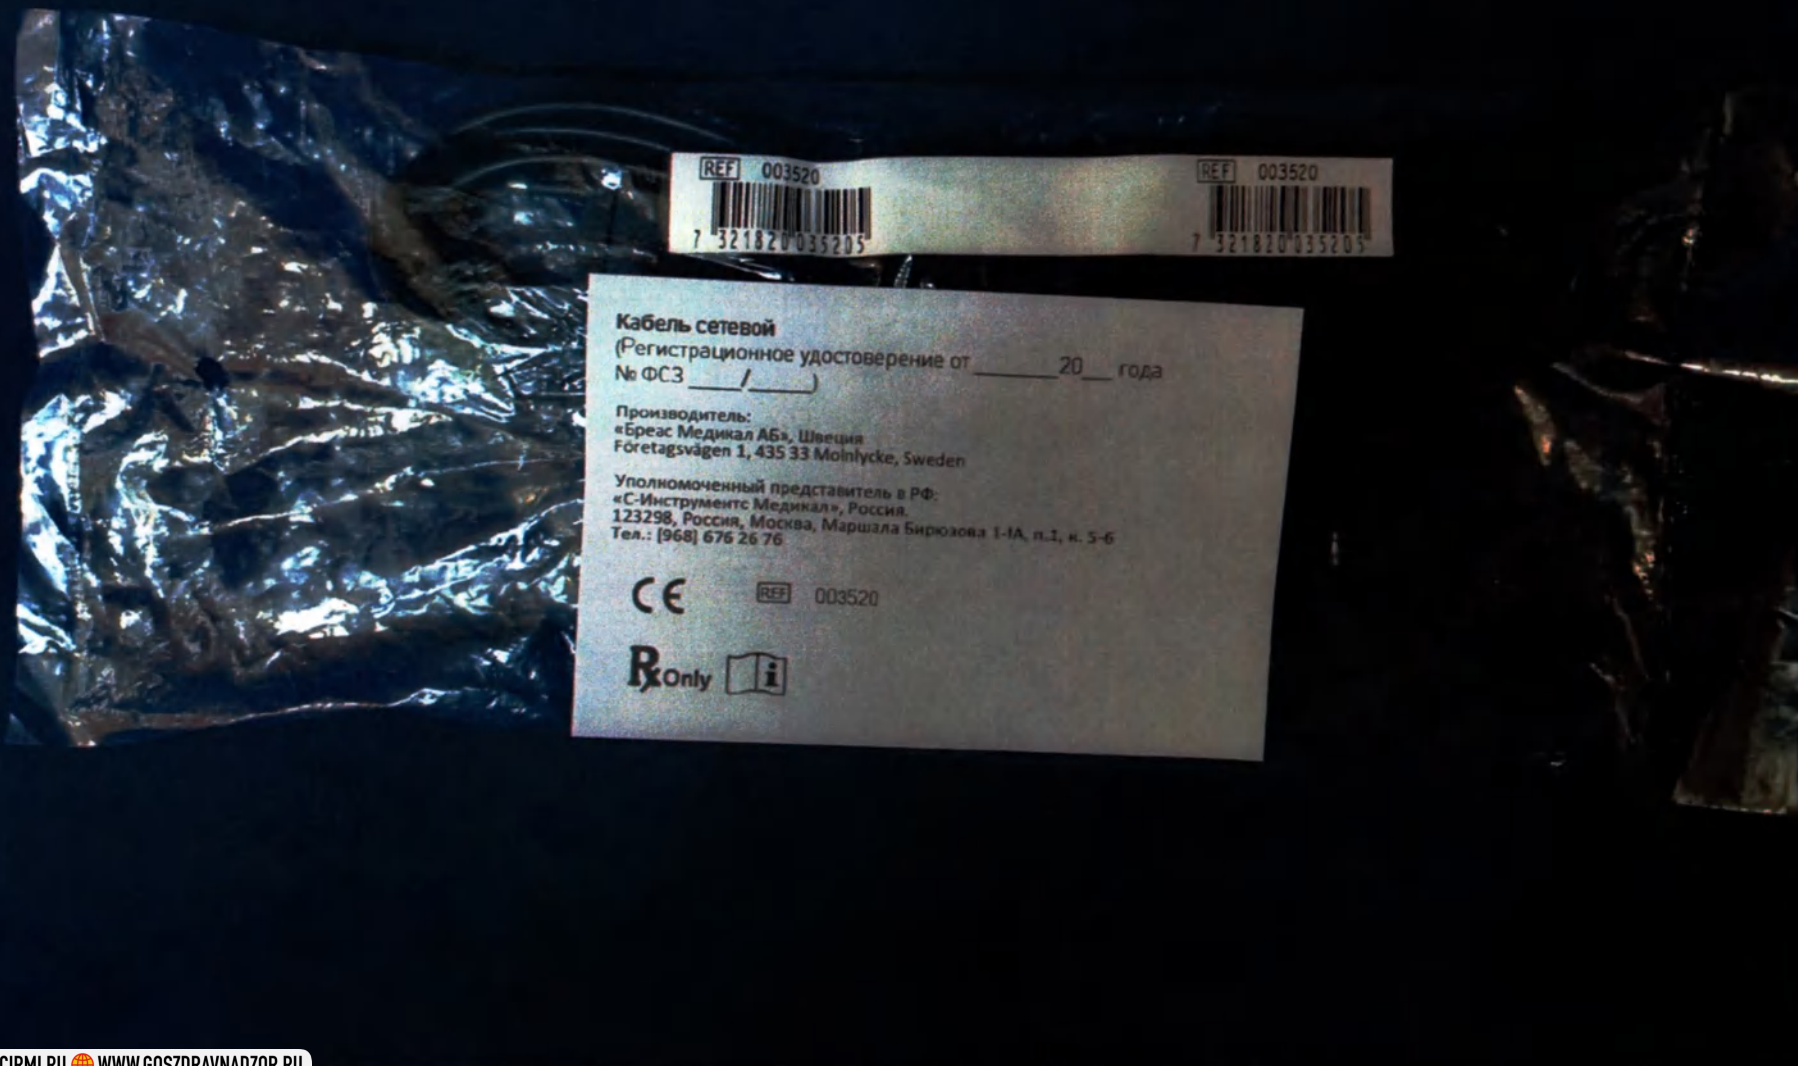

Кабель сетевой


(Регистрационное удостоверение от ____ 20__ года
№ ФСЗ ____/____)

Производитель:
«Брегас Медикал АБ», Швеция
Företagsvägen 1, 435 33 Molnlycke, Sweden

Уполномоченный представитель в РФ:
«С-Инструментс Медикал», Россия,
123298, Россия, Москва, Маршала Бирюзова 1-1А, п.1, к. 5-6
Тел.: [968] 676 26 76



REF 003520



Штуцер кислорода низкого давления

(Регистрационное удостоверение от _____ 20____
года № ФСЗ _____ / _____)

Производитель:
"Колли Флоутек АБ", Швеция
Box 81, 164 94, KISTA
Изготовлено в США

Поставщик:
«Бреас Медикал АБ», Швеция
Företagsvägen 1, 435 33 Molnlycke, Sweden

Уполномоченный представитель в РФ:
«С-Инструментс Медикал», Россия.
123298, Россия, Москва, Маршала Бирюзова 1-1А, п.1, к. 5-6
Тел.: [968] 676 26 76

CE
R Only




REF 005032




2022-03-21

2027-03-21

9. Сумка для транспортировки

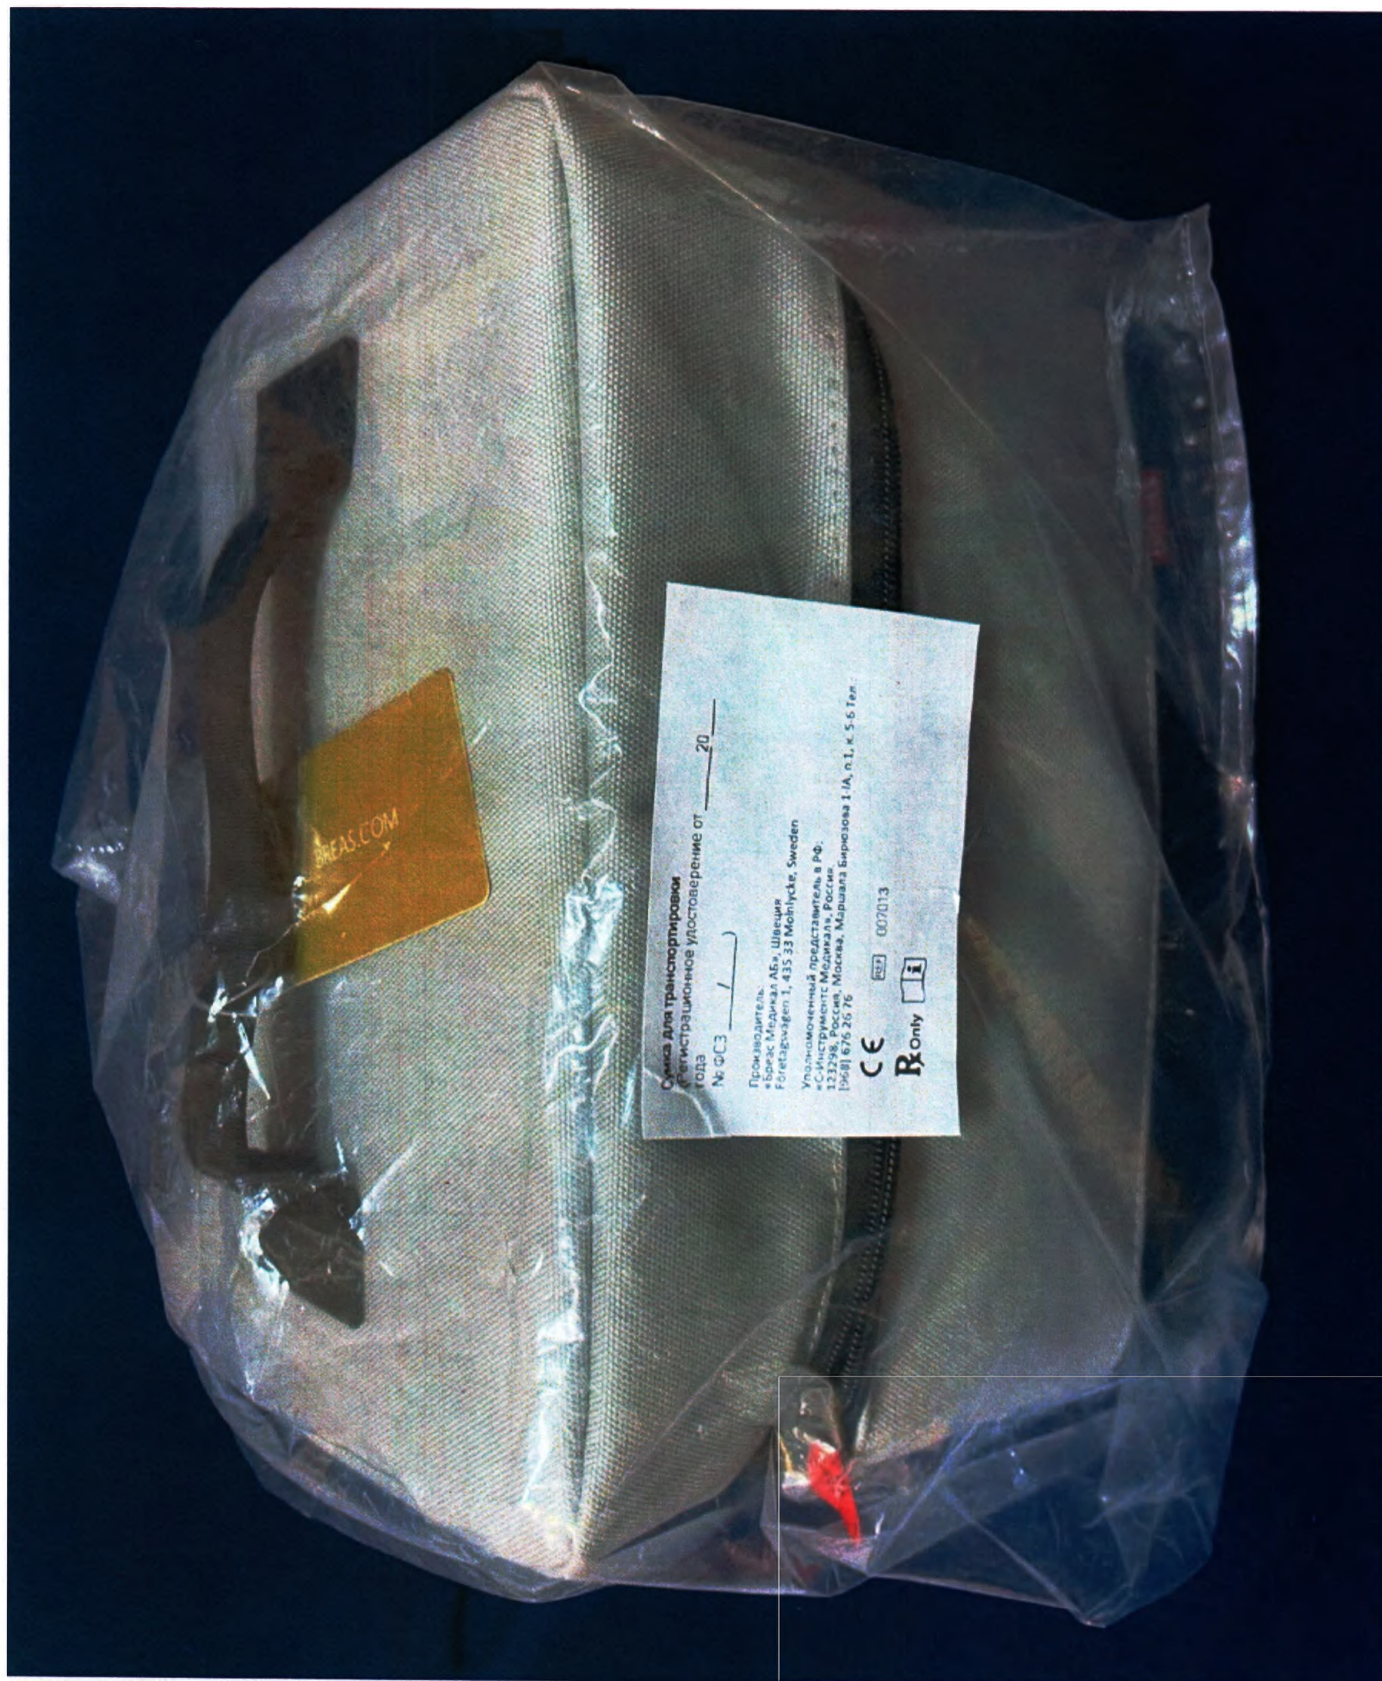

10. Контур пациента односоставной диаметром 15 мм, индивидуальный

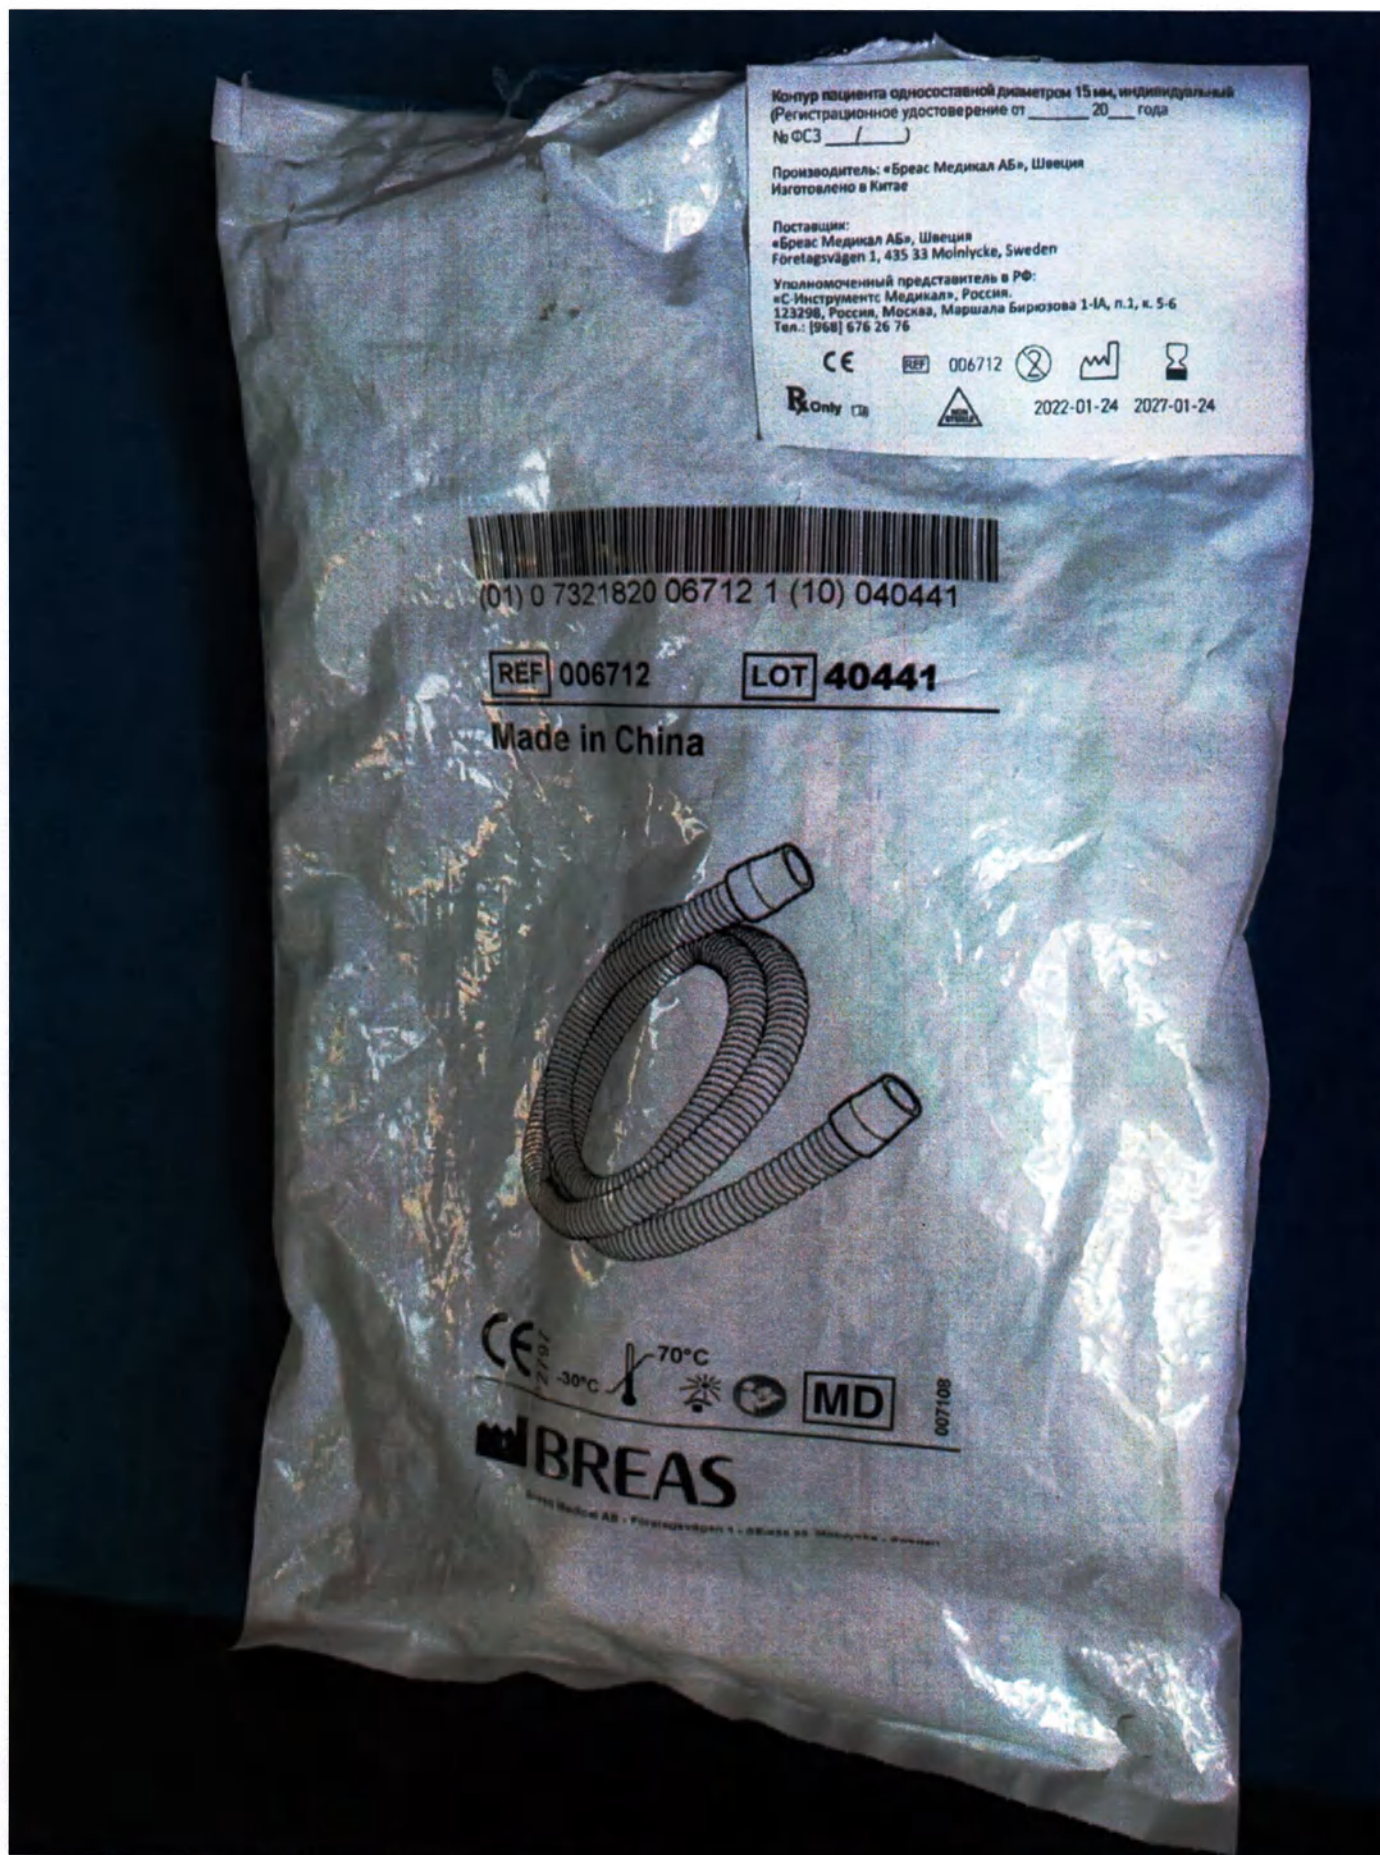

Контур пациента односоставной диаметром 15 мм, индивидуальный
(Регистрационное удостоверение от _____ 20__ года
№ ФСЗ _____)

Производитель: «Бреас Медикал АБ», Швеция
Изготовлено в Китае

Поставщик:
«Бреас Медикал АБ», Швеция
Företagsvägen 1, 435 33 Molnlycke, Sweden

Уполномоченный представитель в РФ:
«С-Инструментс Медикал», Россия.
123298, Россия, Москва, Маршала Бирюзова 1-1А, п.1, к. 5-6
Тел.: [968] 676 26 76

CE

REF

006712



R_{Only}



2022-01-24 2027-01-24



(01) 07321820 06712 1 (10) 040441

REF

006712

LOT


40441


Made in China

10. Контур пациента односоставной диаметром 15 мм, индивидуальный – продолжение



11. Контур пациента одноставной диаметром 22 мм, индивидуальный

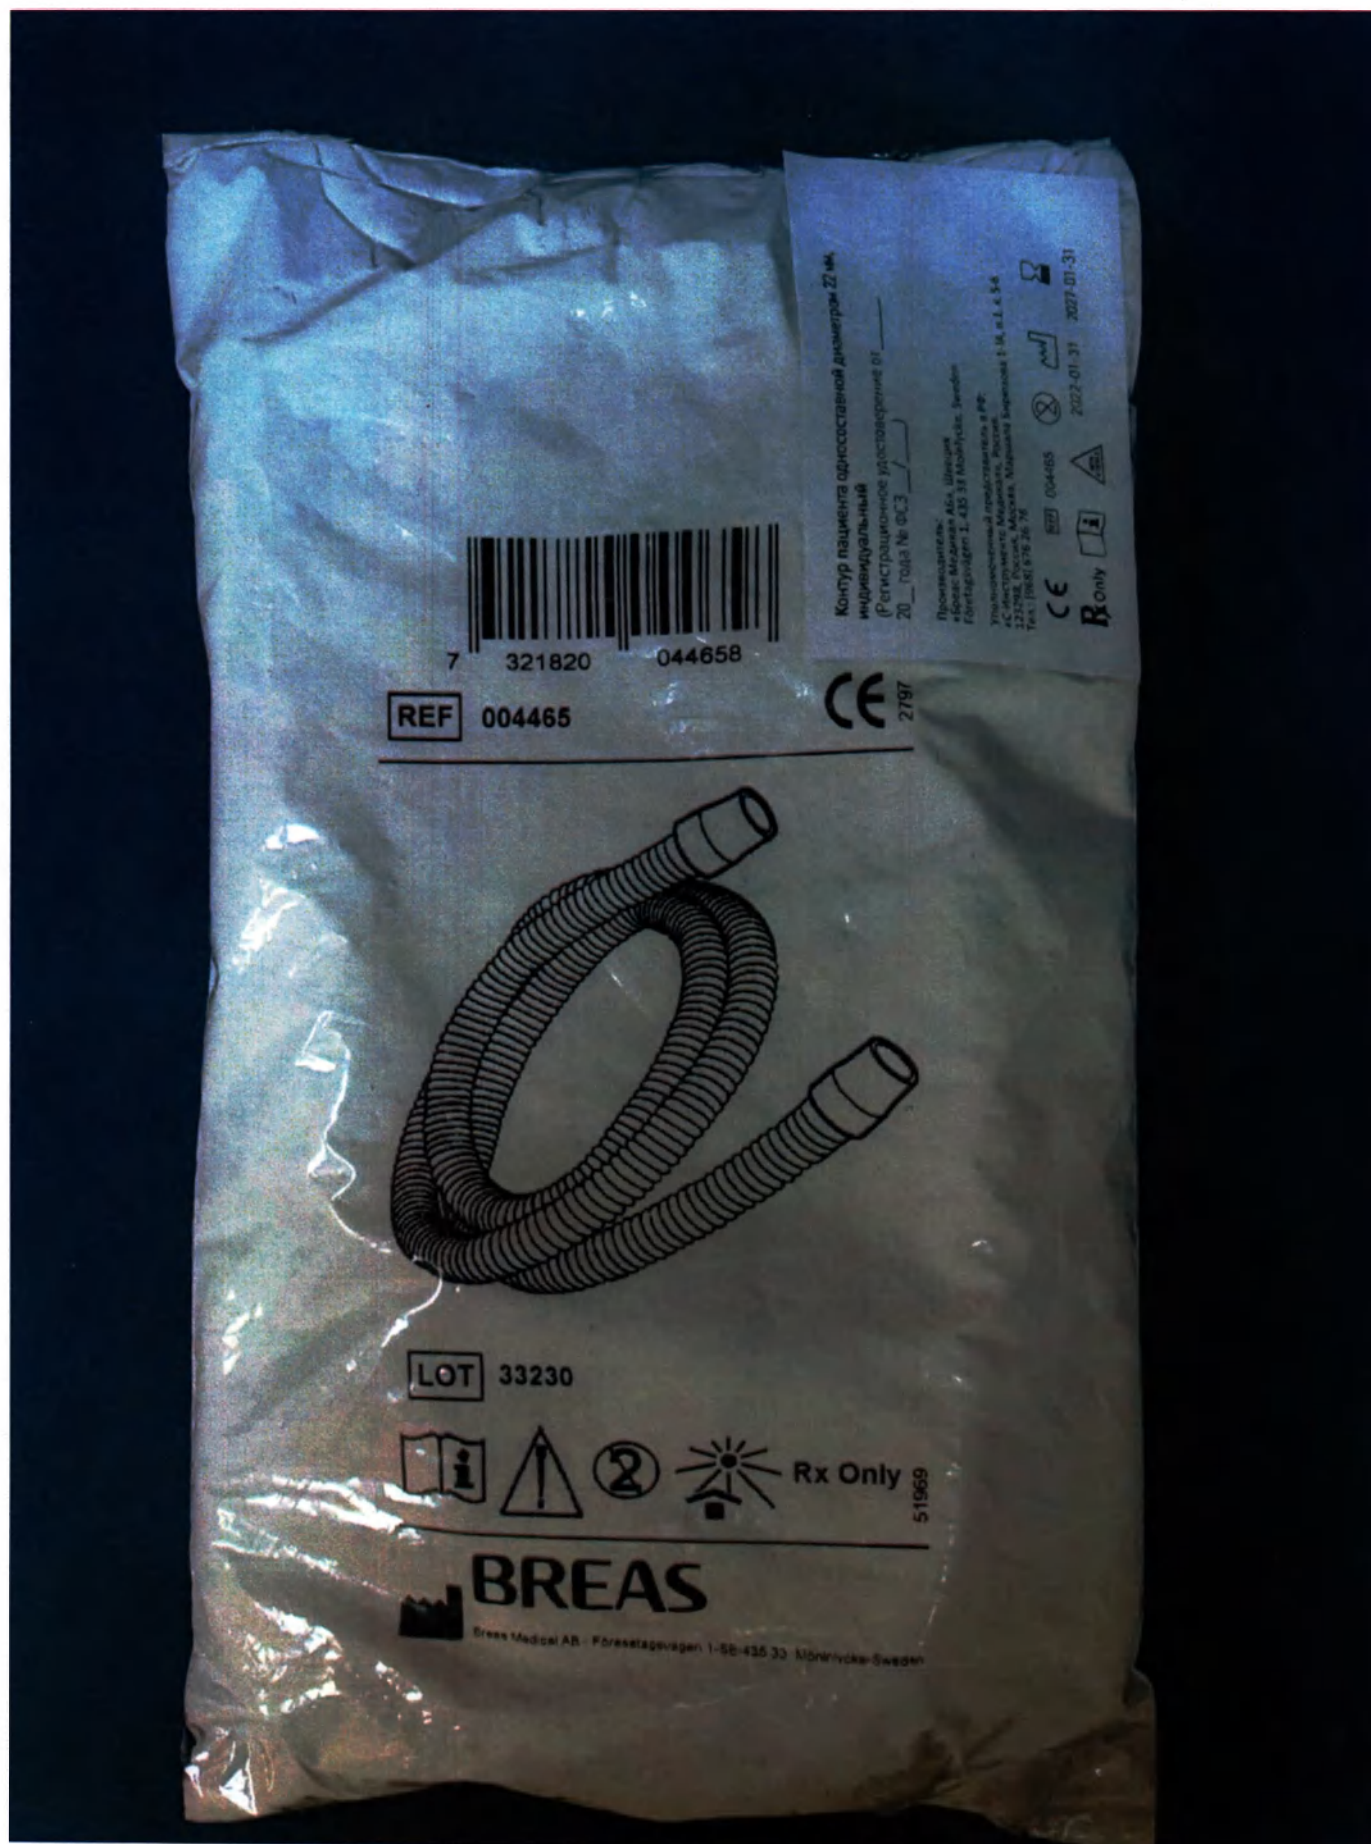

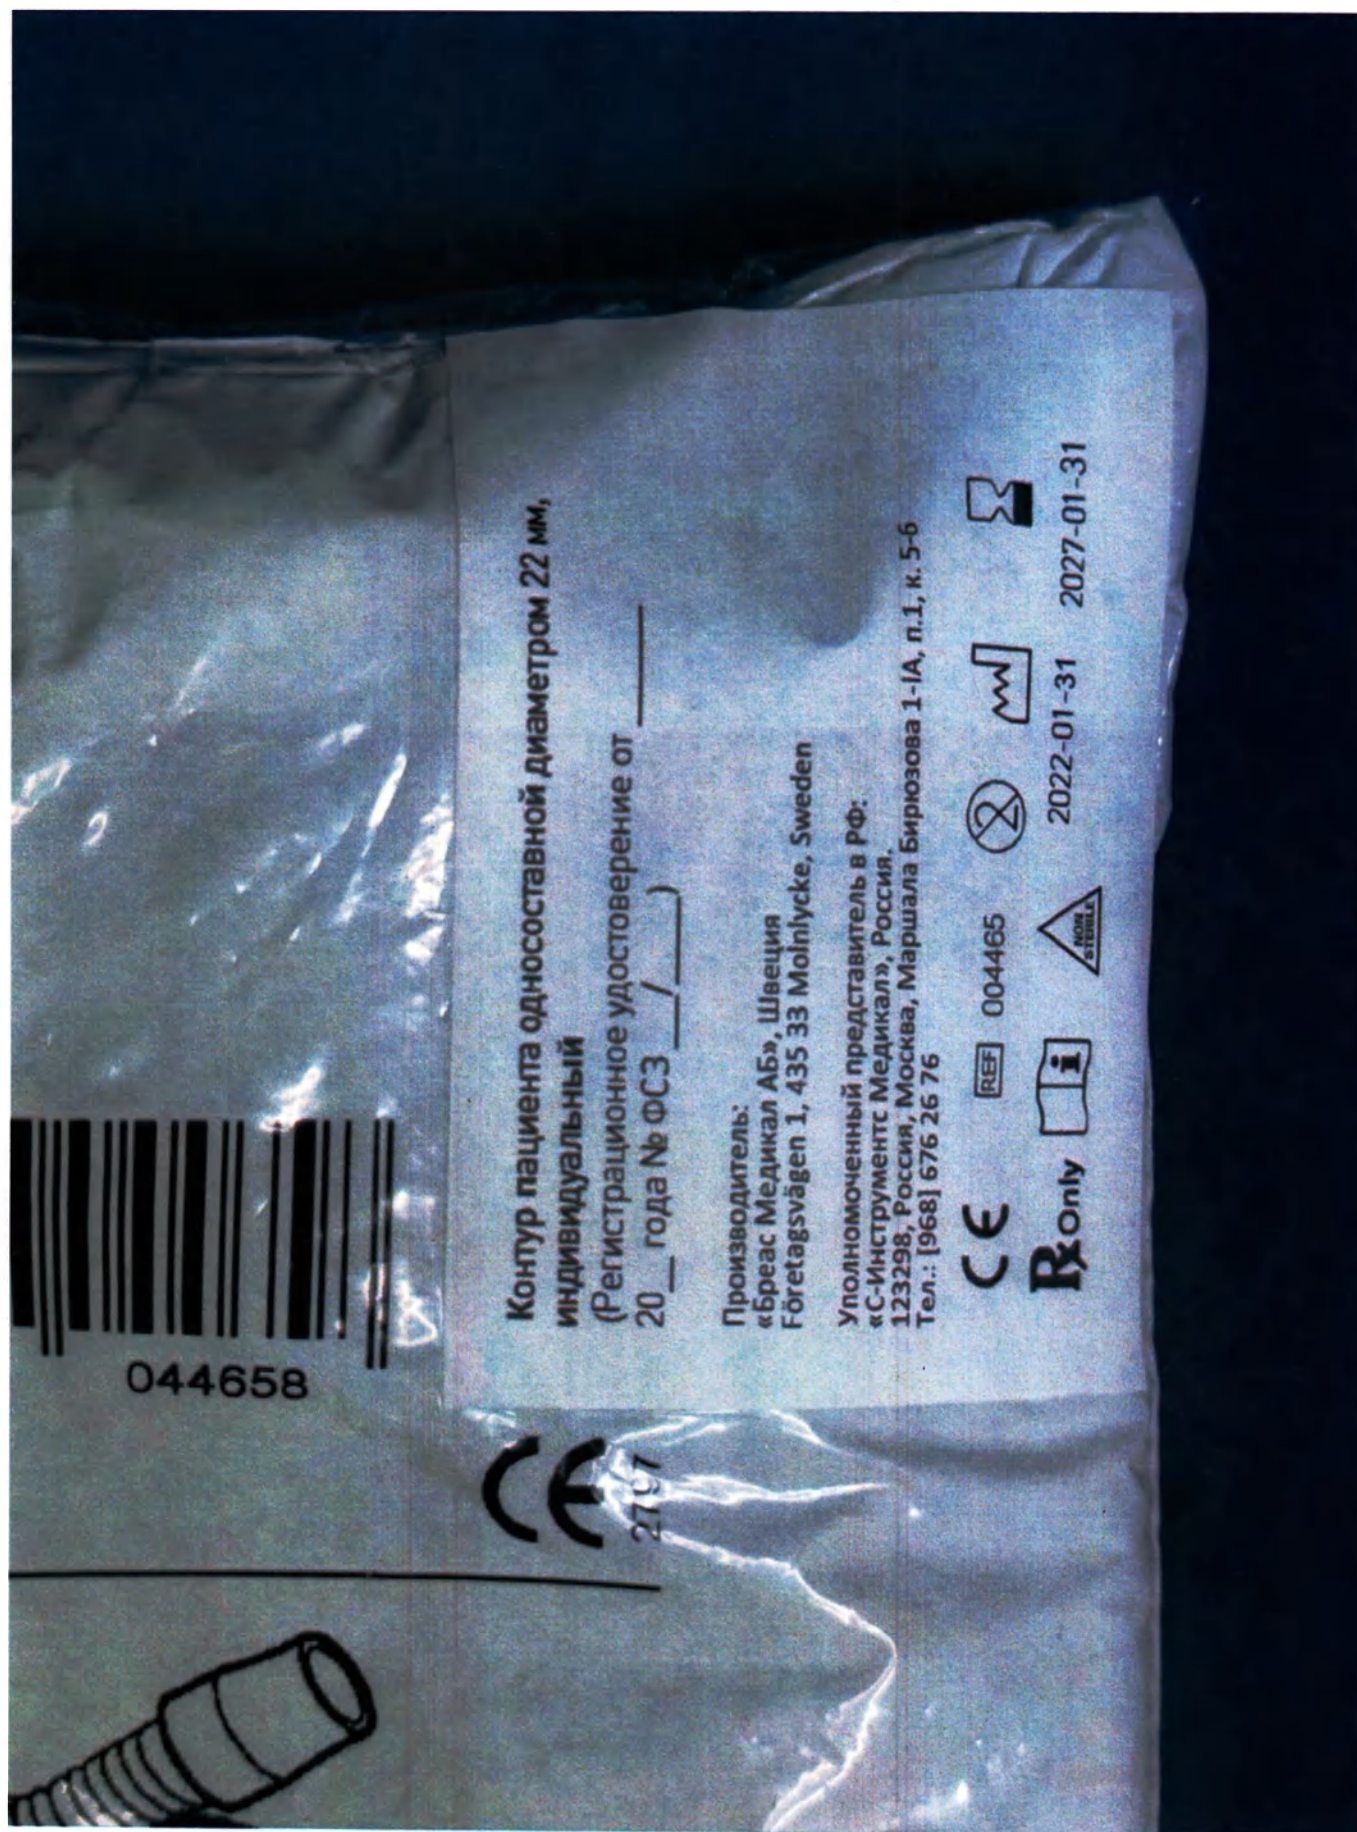

11. Контур пациента односоставной диаметром 22 мм, индивидуальный – продолжение



12. Контур пациента односоставной диаметром 15 мм, подогреваемый





Контур пациента односторонней диафрагмы 22 см, с фильтром
антибактериальным низким сопротивлением, интубационный
Фитинг: Трансформатор, регулирование от 20

Год выпуска (G.D.)

Производитель:
"Medipara Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş." - Turkey
Büyükdere Caddesi No: 25, Kat: 25, 33060 Teşvikiye, Turkey

Дистрибутор:
"Brest Medikal A.Ş." - Turkey
Ticaretler Sokağı, 433 81 Marmaris, Turkey

Исходный номер партии: 6137
М.А.С. (M.A.S.) - Механика, Россия
52738, Россия, Москва, Механика, Механика 1 05, м.А.С. 1-4 Тел: (800) 035 75 75

CE
Rx Only
007936
2021-04-09
2026-04-09

1984

22mm Breathing Circuit / AB filter

09/04/2026

Quantity: 1

Rx Only


Distributed by
BREAS
Brest Medikal A.Ş. - Turkey
Ticaretler Sokağı, 433 81 Marmaris, Turkey

Medipara Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Caddesi No: 25, Kat: 25, 33060 Teşvikiye, Turkey
Tel: +90 212 512 51 51
Fax: +90 212 512 51 51
E-mail: info@medipara.com.tr

A/P 04 ALT.BH.C002-REV.01

PEW

13. Контур пациента одноставной диаметром 22 мм, с фильтром антибактериальным низкого сопротивления, индивидуальный

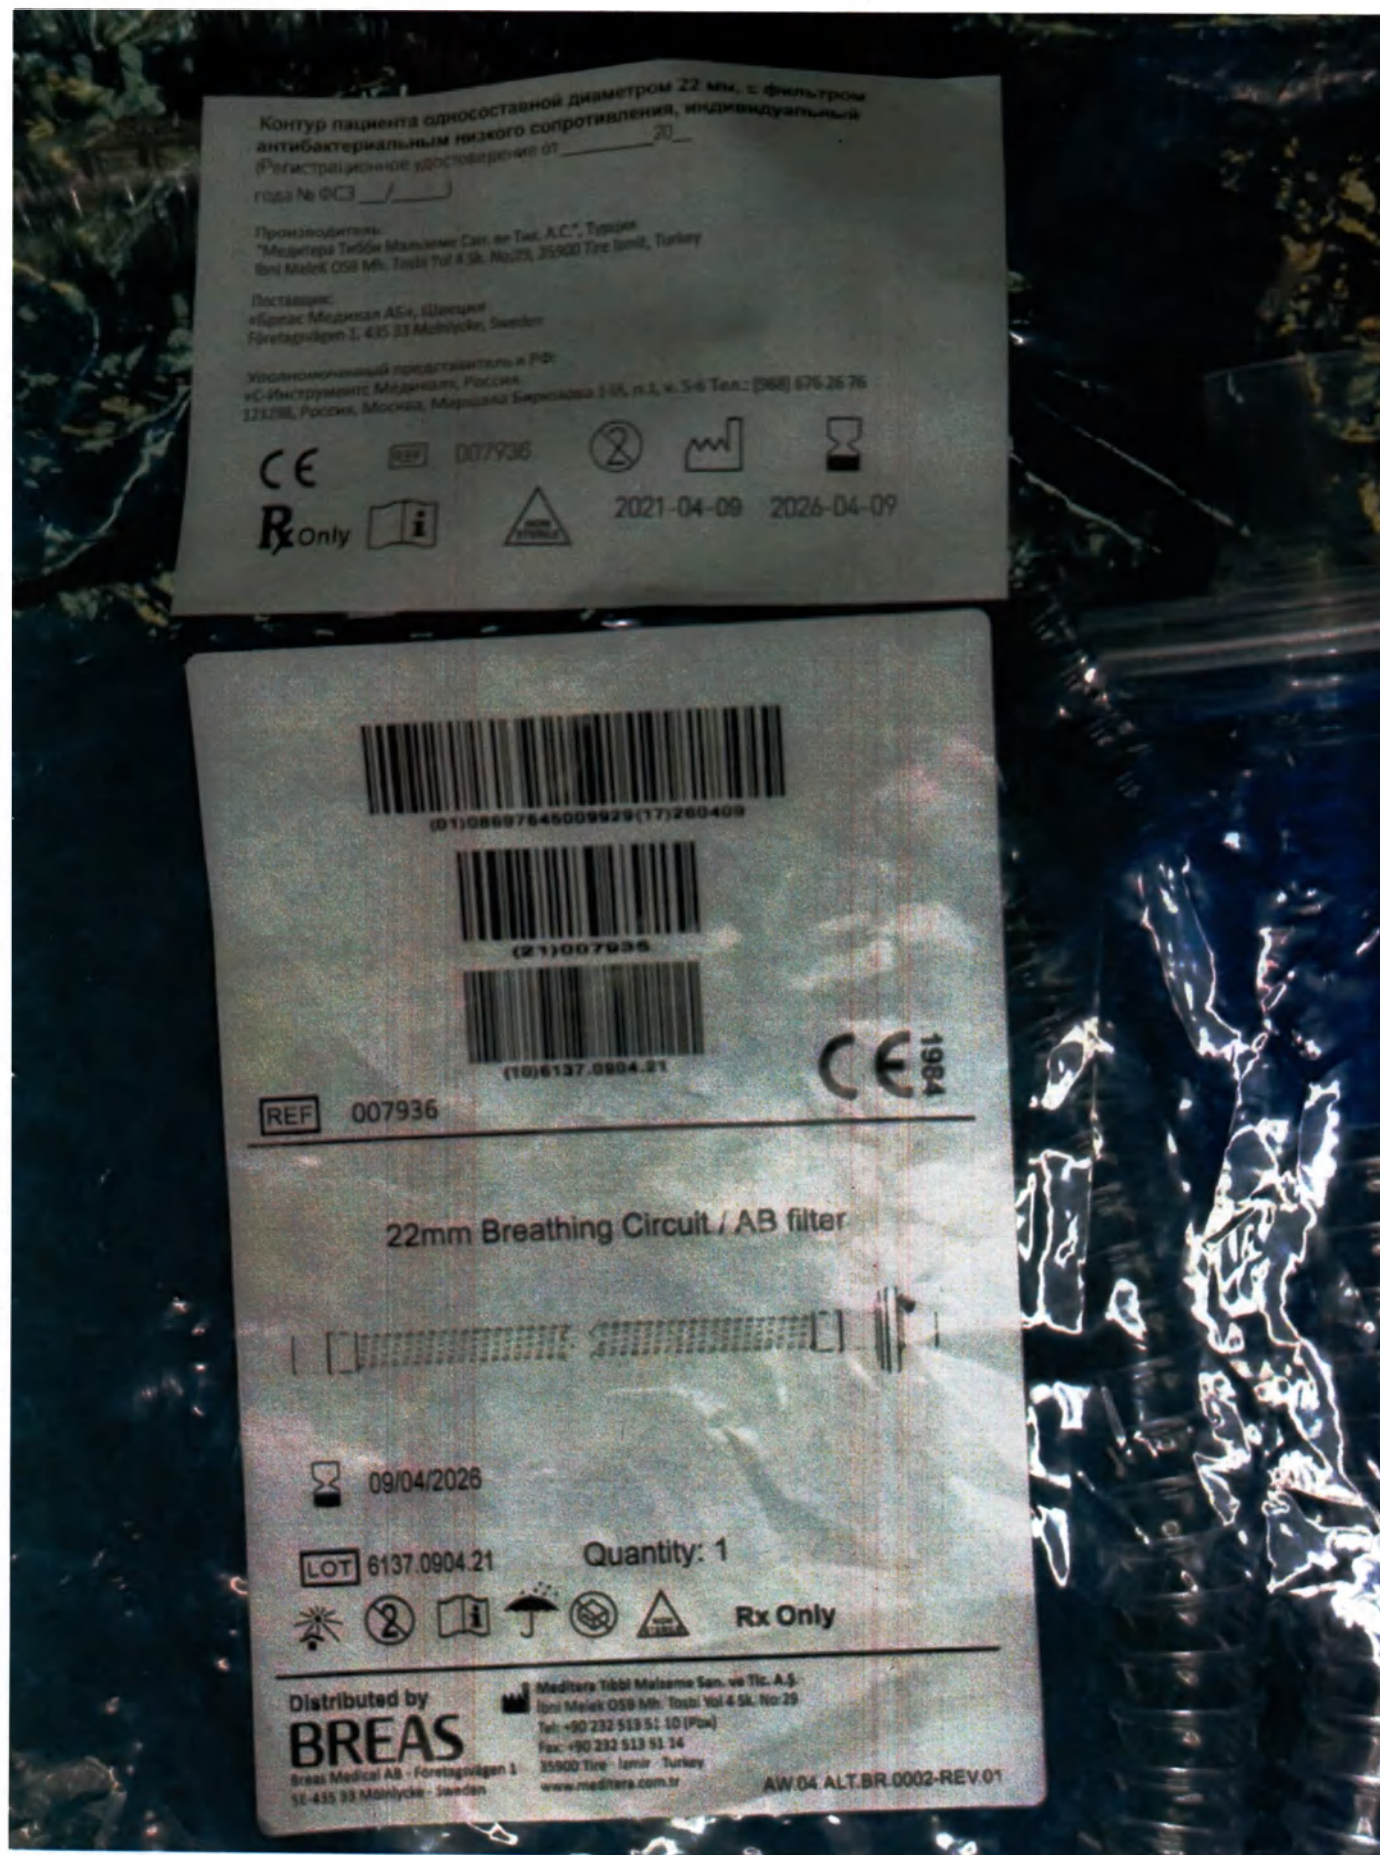


14. Порт утечки



15. Патрубок утечки



16. Фильтр антибактериальный низкого сопротивления

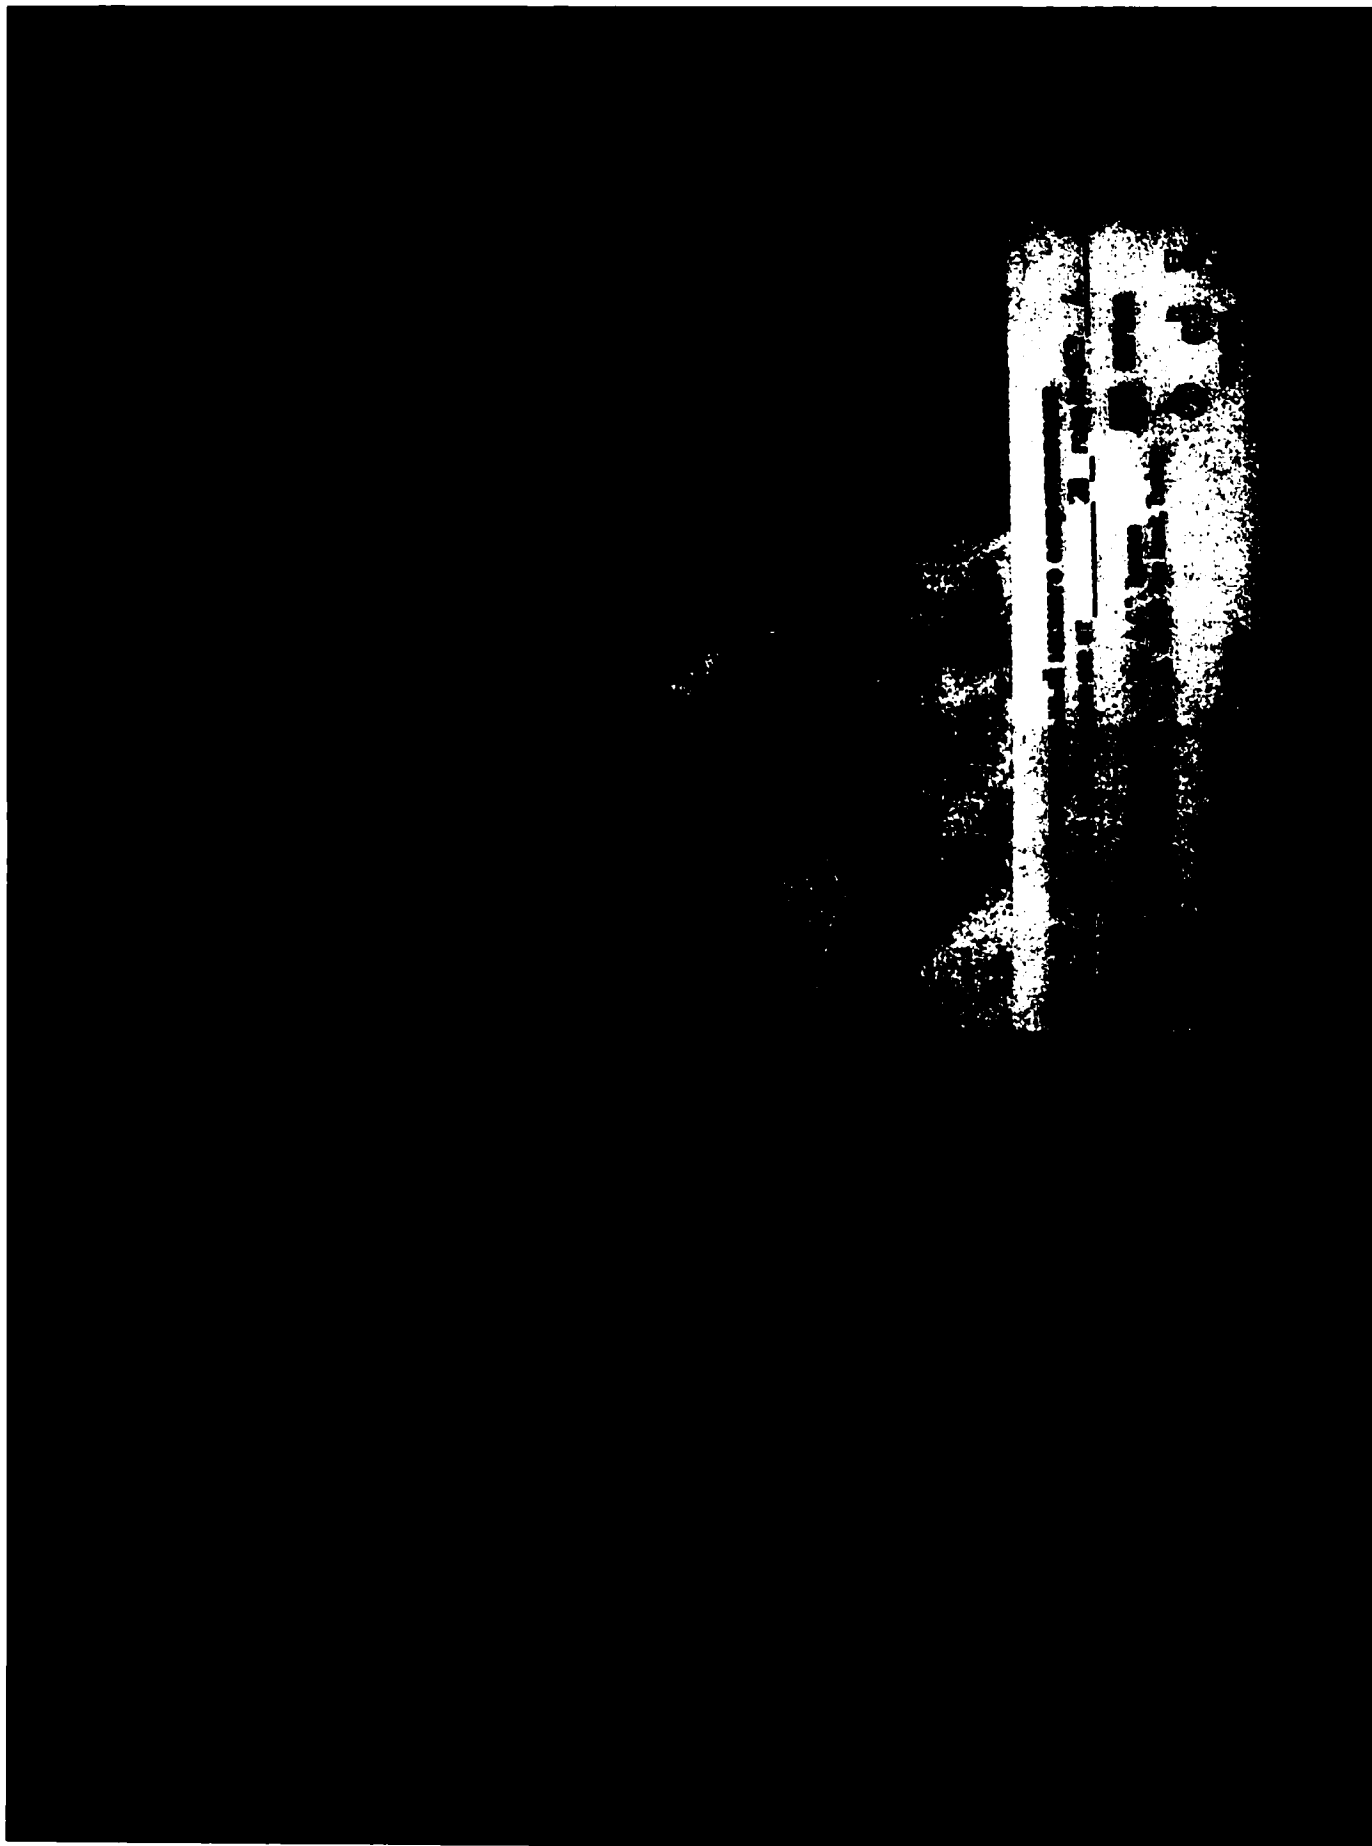

Увлажнитель встраиваемый

(Регистрационное удостоверение от _____ 20____
года № ФСЗ _____ / _____)

Производитель:

«Бреас Медикал АБ», Швеция
Företagsvägen 1, 435 33 Molnlycke, Sweden

Уполномоченный представитель в РФ:

«С-Инструментс Медикал», Россия.
123298, Россия, Москва, Маршала Бирюзова 1-1А, п.1, к. 5-6
Тел.: [968] 676 26 76



REF 006977




Rx Only




2022-03-07

2027-03-07

18. Кабель, адаптер внешнего источника постоянного тока

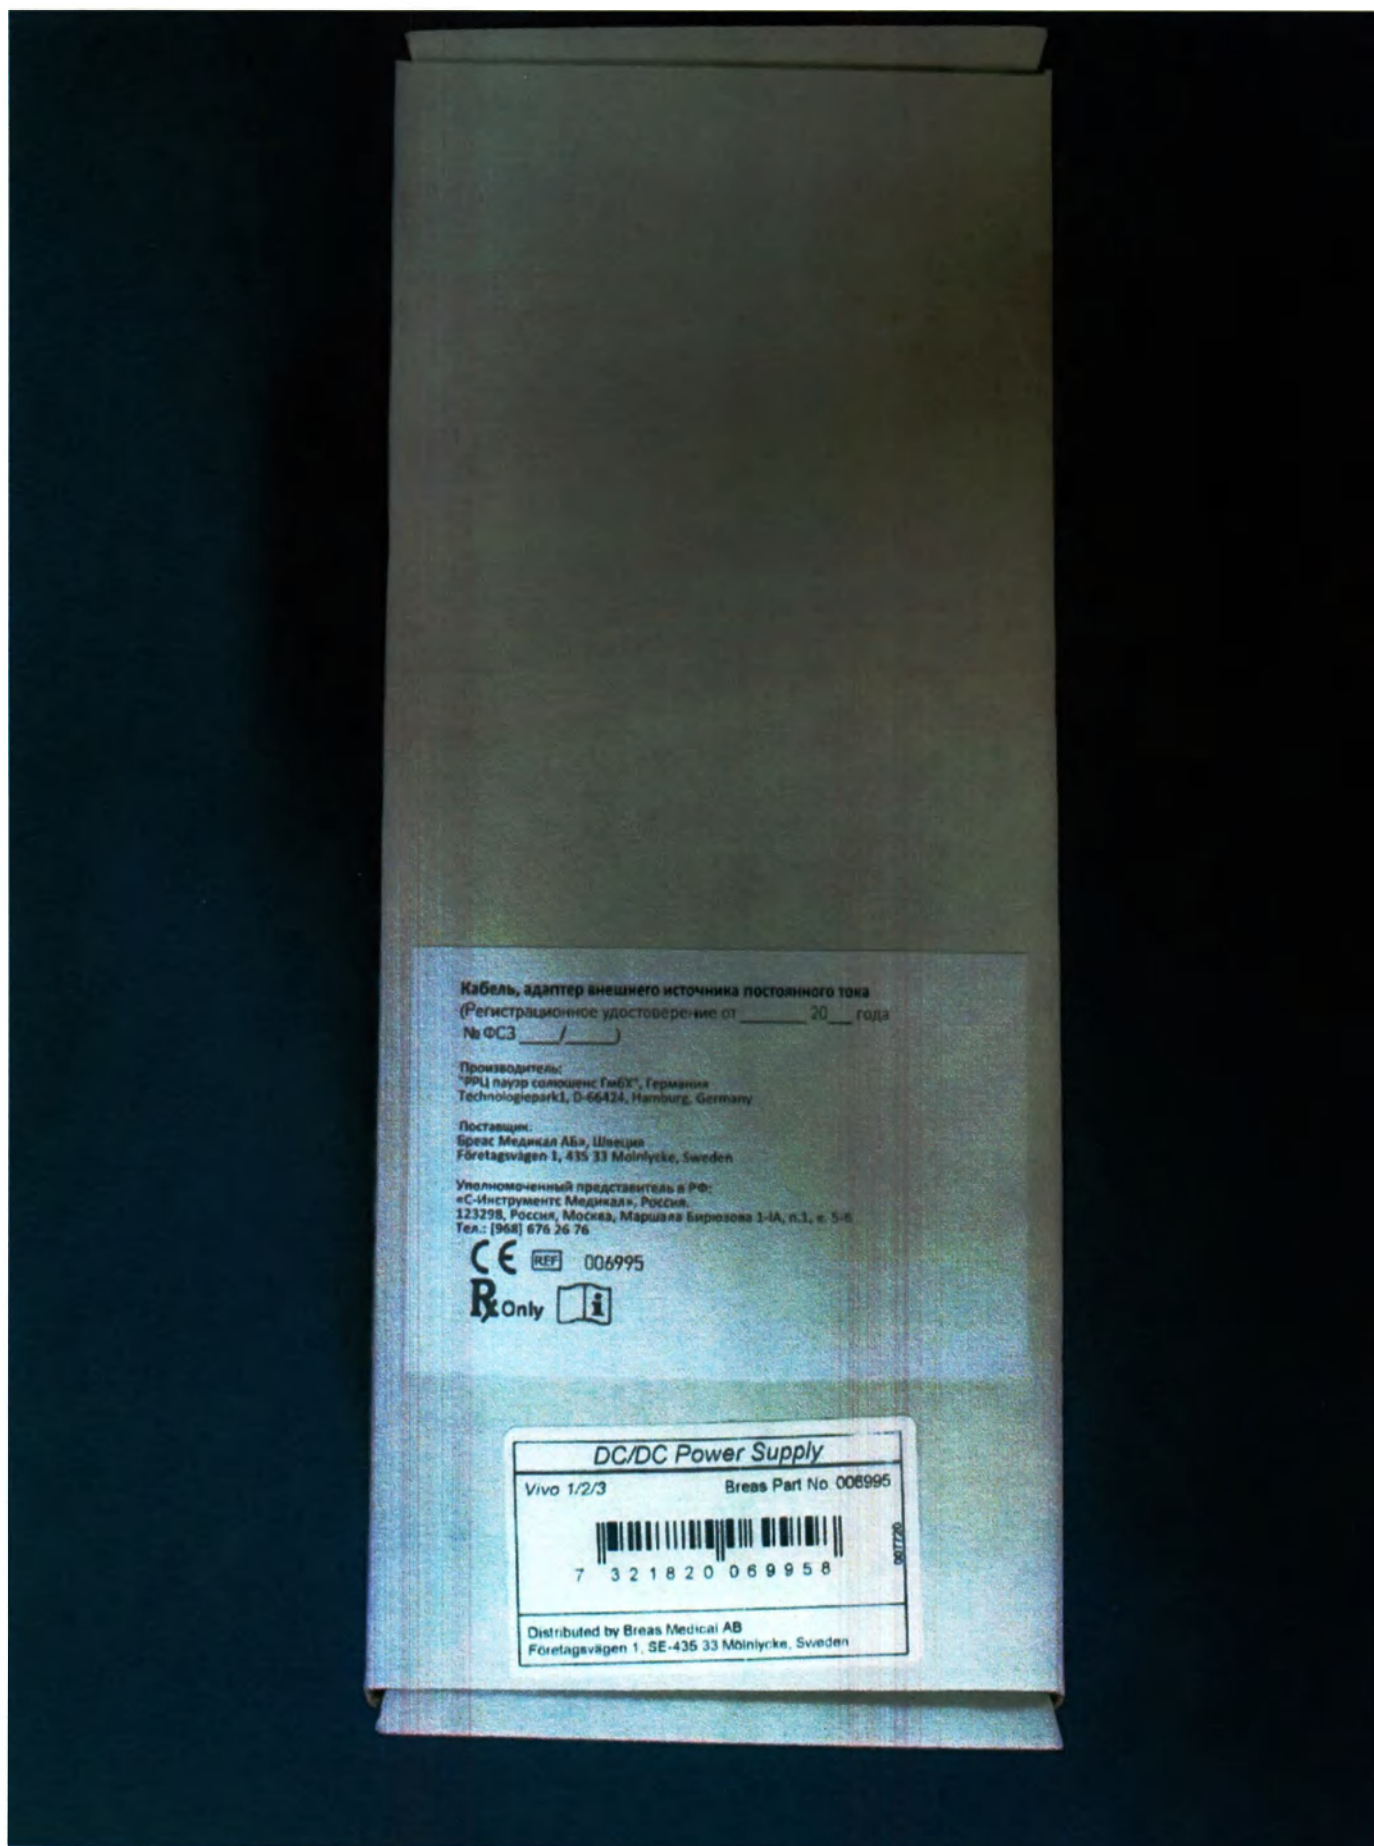

19. Y-кабель для одновременного подключения аппарата к электропитанию переменного и постоянного токов

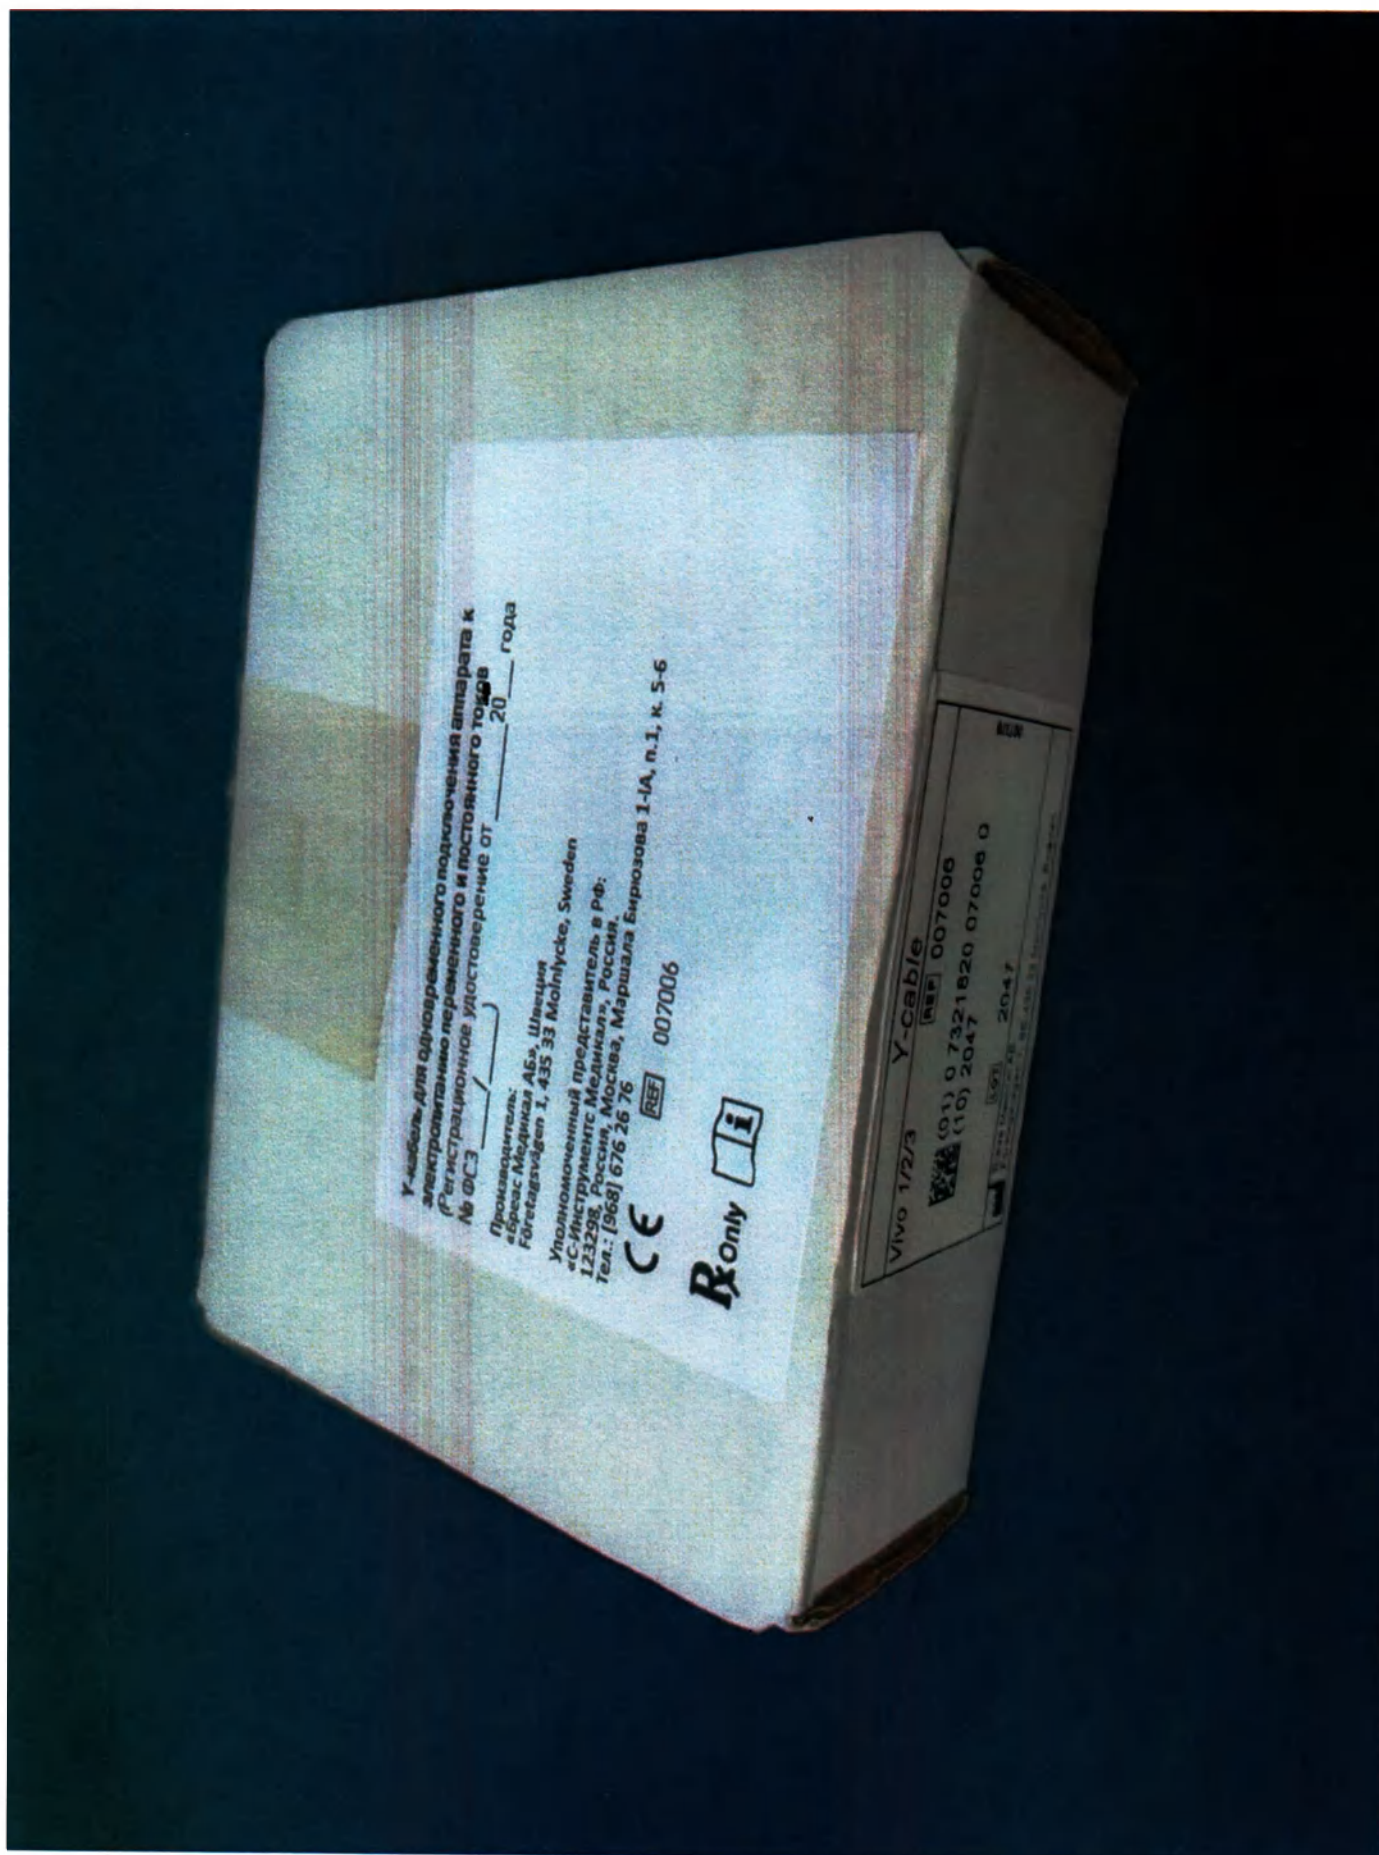

19. Y-кабель для одновременного подключения аппарата к электропитанию переменного и постоянного токов – продолжение

Y-cable	
Vivo 1/2/3	REF 007006
 (01) 0 7321820 07006 0 (10) 2047	007378
LOT 2047	
 Breas Medical AB Företagsvägen 1, SE-435 33 Mölnlycke, Sweden	

20. Кабель для подключения датчика синхронизации по периферическому пульсу



21. Модуль сопряжения SpO2



**Датчик синхронизации по периферическому
пульсу, тип клипса, для взрослых**
(Регистрационное удостоверение от _____
20__ года № ФСЗ ____/____)

Производитель:
"Масимо Корпорейшен", США
52 Discovery, Irvine, CA 92618, USA

Поставщик:
«Бреас Медикал АБ», Швеция
Företagsvägen 1, 435 33 Molnlycke, Sweden

Уполномоченный представитель в РФ:
«С-Инструментс Медикал», Россия.
123298, Россия, Москва, Маршала Бирюзова 1-1А, п.1, к. 5-6
Тел.: [968] 676 26 76



R_xOnly




006589





> 30 kg

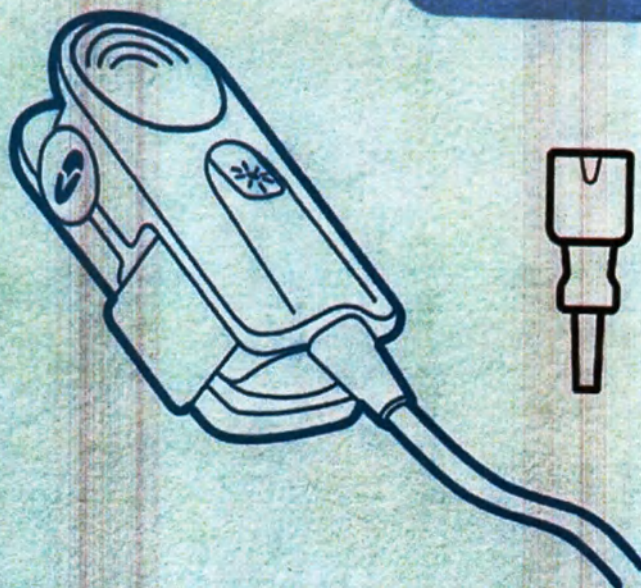

LNCs® DCI® SpO₂

Adult Reusable Finger Clip Sensor

1	LNCs DCI
---	----------

3 ft./0.9 m.

LNCS[®] DCI[®] SpO₂

Adult Reusable Finger Clip Sensor

REF 1863

LOT 20G5J

20G5J



(01)00843997000406
(11)200701
(10)20G5J


 **MASIMO**

Designed by Masimo in California
Assembled in Mexico
www.masimo.com


 Masimo Corporation
52 Discovery, Irvine, CA 92618 USA
Patents: <http://www.masimo.com/patents.htm>



0123



MDSS GmbH Schiffgraben
41 D-30175 Hannover Germany



> 30 kg

GS1-128



(01) 00843997000406 (11) 200701 (10) 20G5J

 2020-07-01

BTW2529F-0718

SpO2 Sensor, Finger Clip, Adult

Breas Part No. 006589



(01) 0 7321820 06589 9

(10) 20G5J

006788

LOT 20G5J

Distributed by Breas Medical AB
Företagsvägen 1, SE-435 33 Mölnlycke, Sweden

22. Датчик синхронизации по периферическому пульсу, тип клипса, для взрослых – продолжение



Датчик синхронизации по периферическому пульсу,
тип клипса, для детей

(Регистрационное удостоверение от _____
20__ года № ФСЗ ____/____)

Производитель:

"Масимо Корпорейшен", США
52 Discovery, Irvine, CA 92618, USA

Поставщик:

«Бреас Медикал АБ», Швеция
Företagsvägen 1, 435 33 Molnlycke, Sweden

Уполномоченный представитель в РФ:

«С-Инструментс Медикал», Россия.
123298, Россия, Москва, Маршала Бирюзова 1-А, п.1, к. 5-6 Тел.:
[968] 676 26 76

CE

R Only


REF

006590





10 - 50 kg

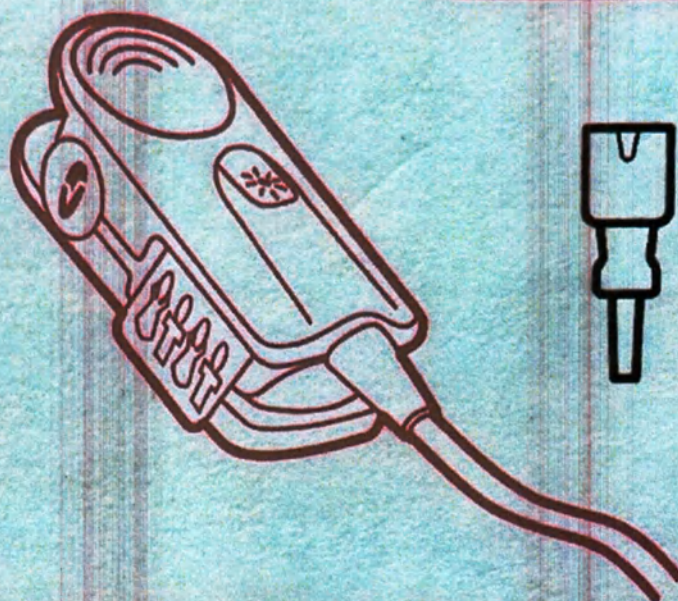

LNCs® DCI-P SpO₂

Pediatric/Slender digit

Reusable Finger Clip Sensor

1

LNCs DCI-P


3 ft./0.9 m.

Designed by Masimo in California
Assembled in Mexico
www.masimo.com


 Masimo Corporation
52 Discovery, Irvine, CA 92618 USA
Patents: <http://www.masimo.com/patents.htm>



0123



MDSS GmbH Schiffgraben
41 D-30175 Hannover Germany



10 - 50 kg

GS1-128



(01)00843997000413(11)191101(10)19MKJ

 2019-11-01

BTW2530E-0718

LNCS® DCI-P SpO2

Pediatric/Slender digit

Reusable Finger Clip Sensor

REF

1864

LOT

19MKJ

19MKJ



(01)00843997000413

(11)191101

(10)19MKJ

 **MASIMO**

23. Датчик синхронизации по периферическому пульсу, тип клипса, для детей – продолжение

SpO2 Sensor, Finger Clip, Ped.

Breas Part No. 006590



(01) 0 7321820 06590 5
(10) 19MKJ

006789

LOT 19MKJ


Distributed by Breas Medical AB
Företagsvägen 1, SE-435 33 Mölnlycke, Sweden

23. Датчик синхронизации по периферическому пульсу, тип клипса, для детей – продолжение




24. Батарея аккумуляторная внешняя, двойная



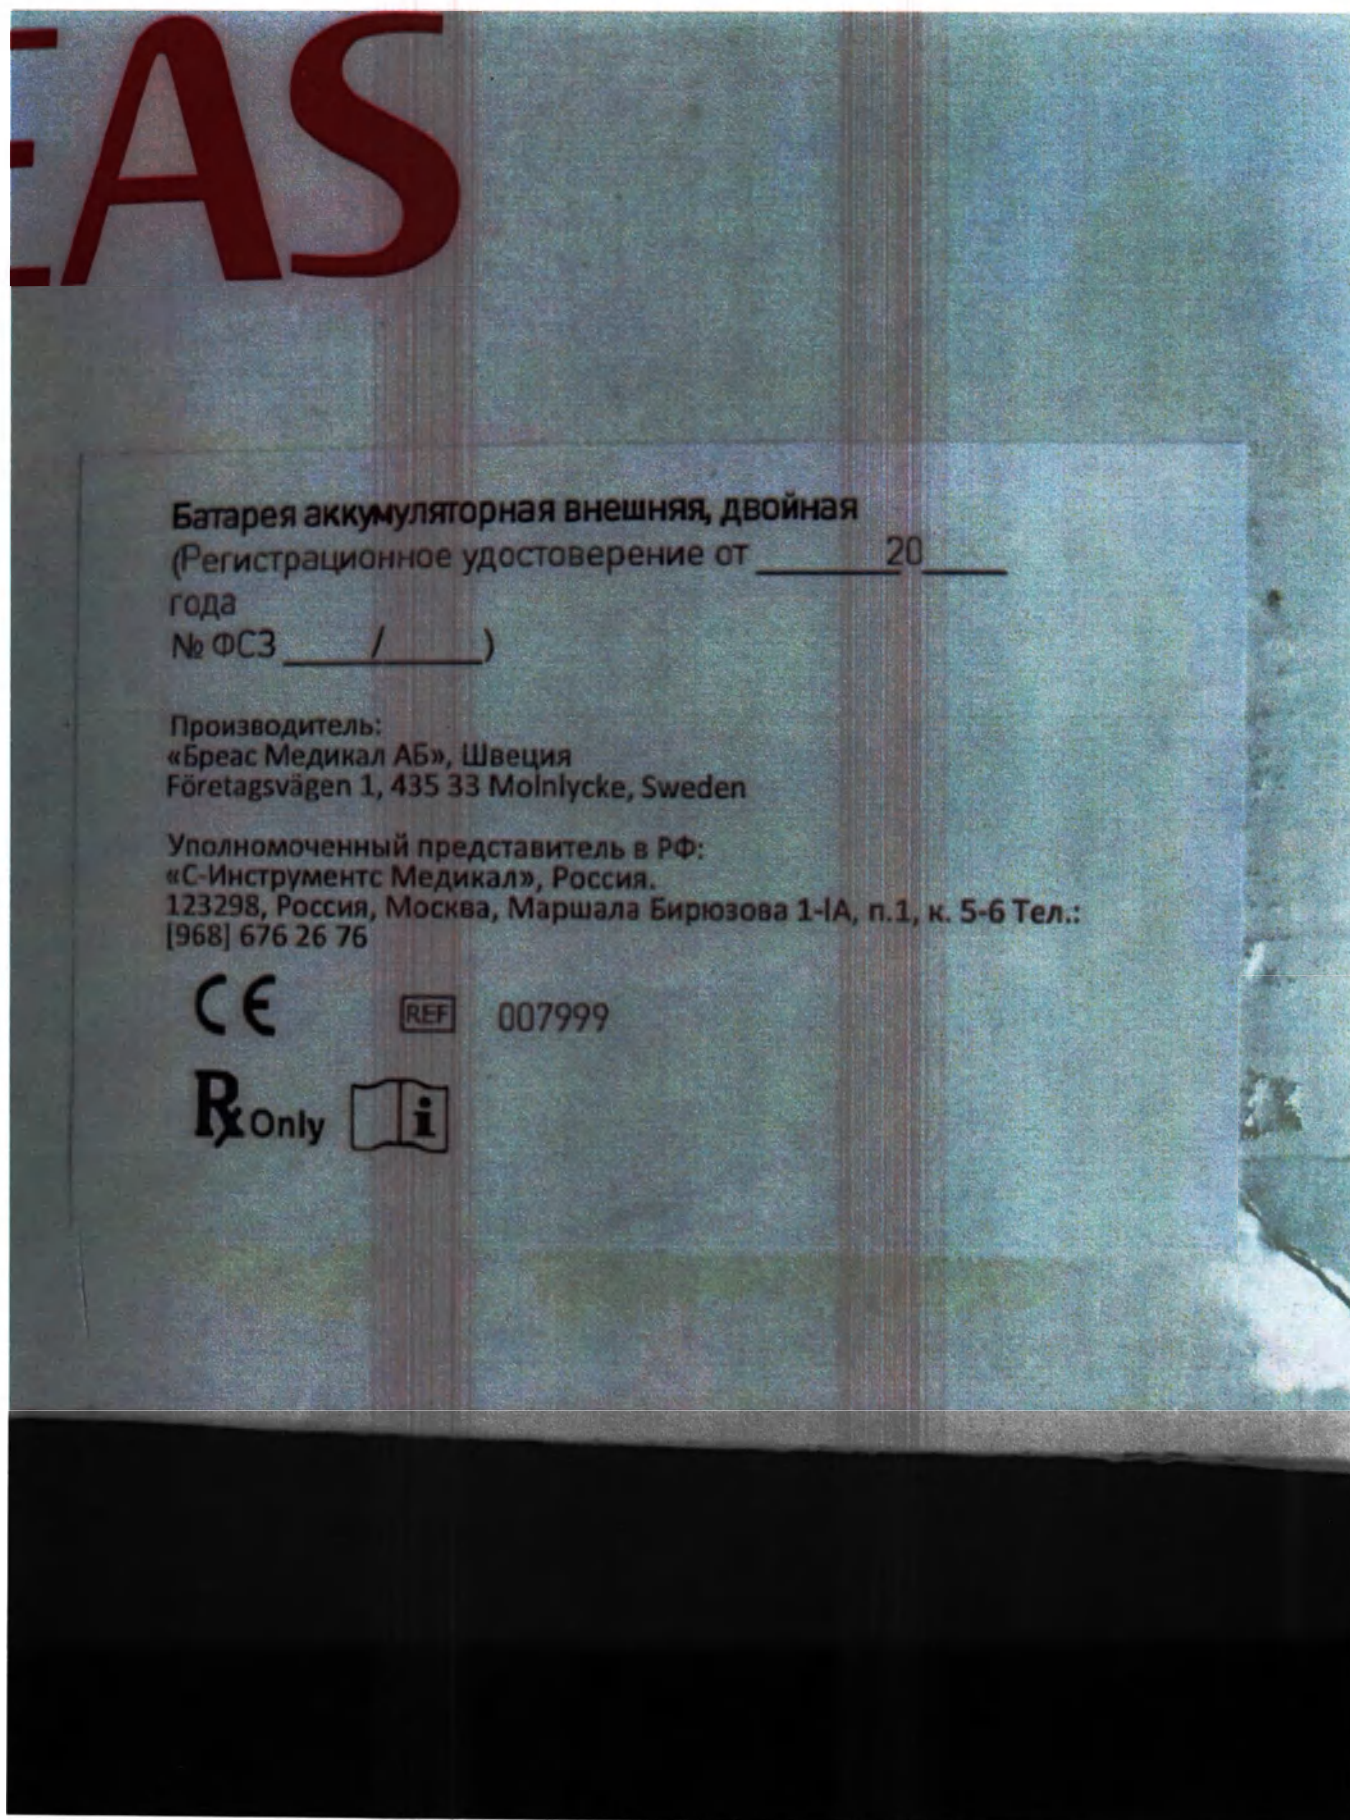


24. Батарея аккумуляторная внешняя, двойная – продолжение

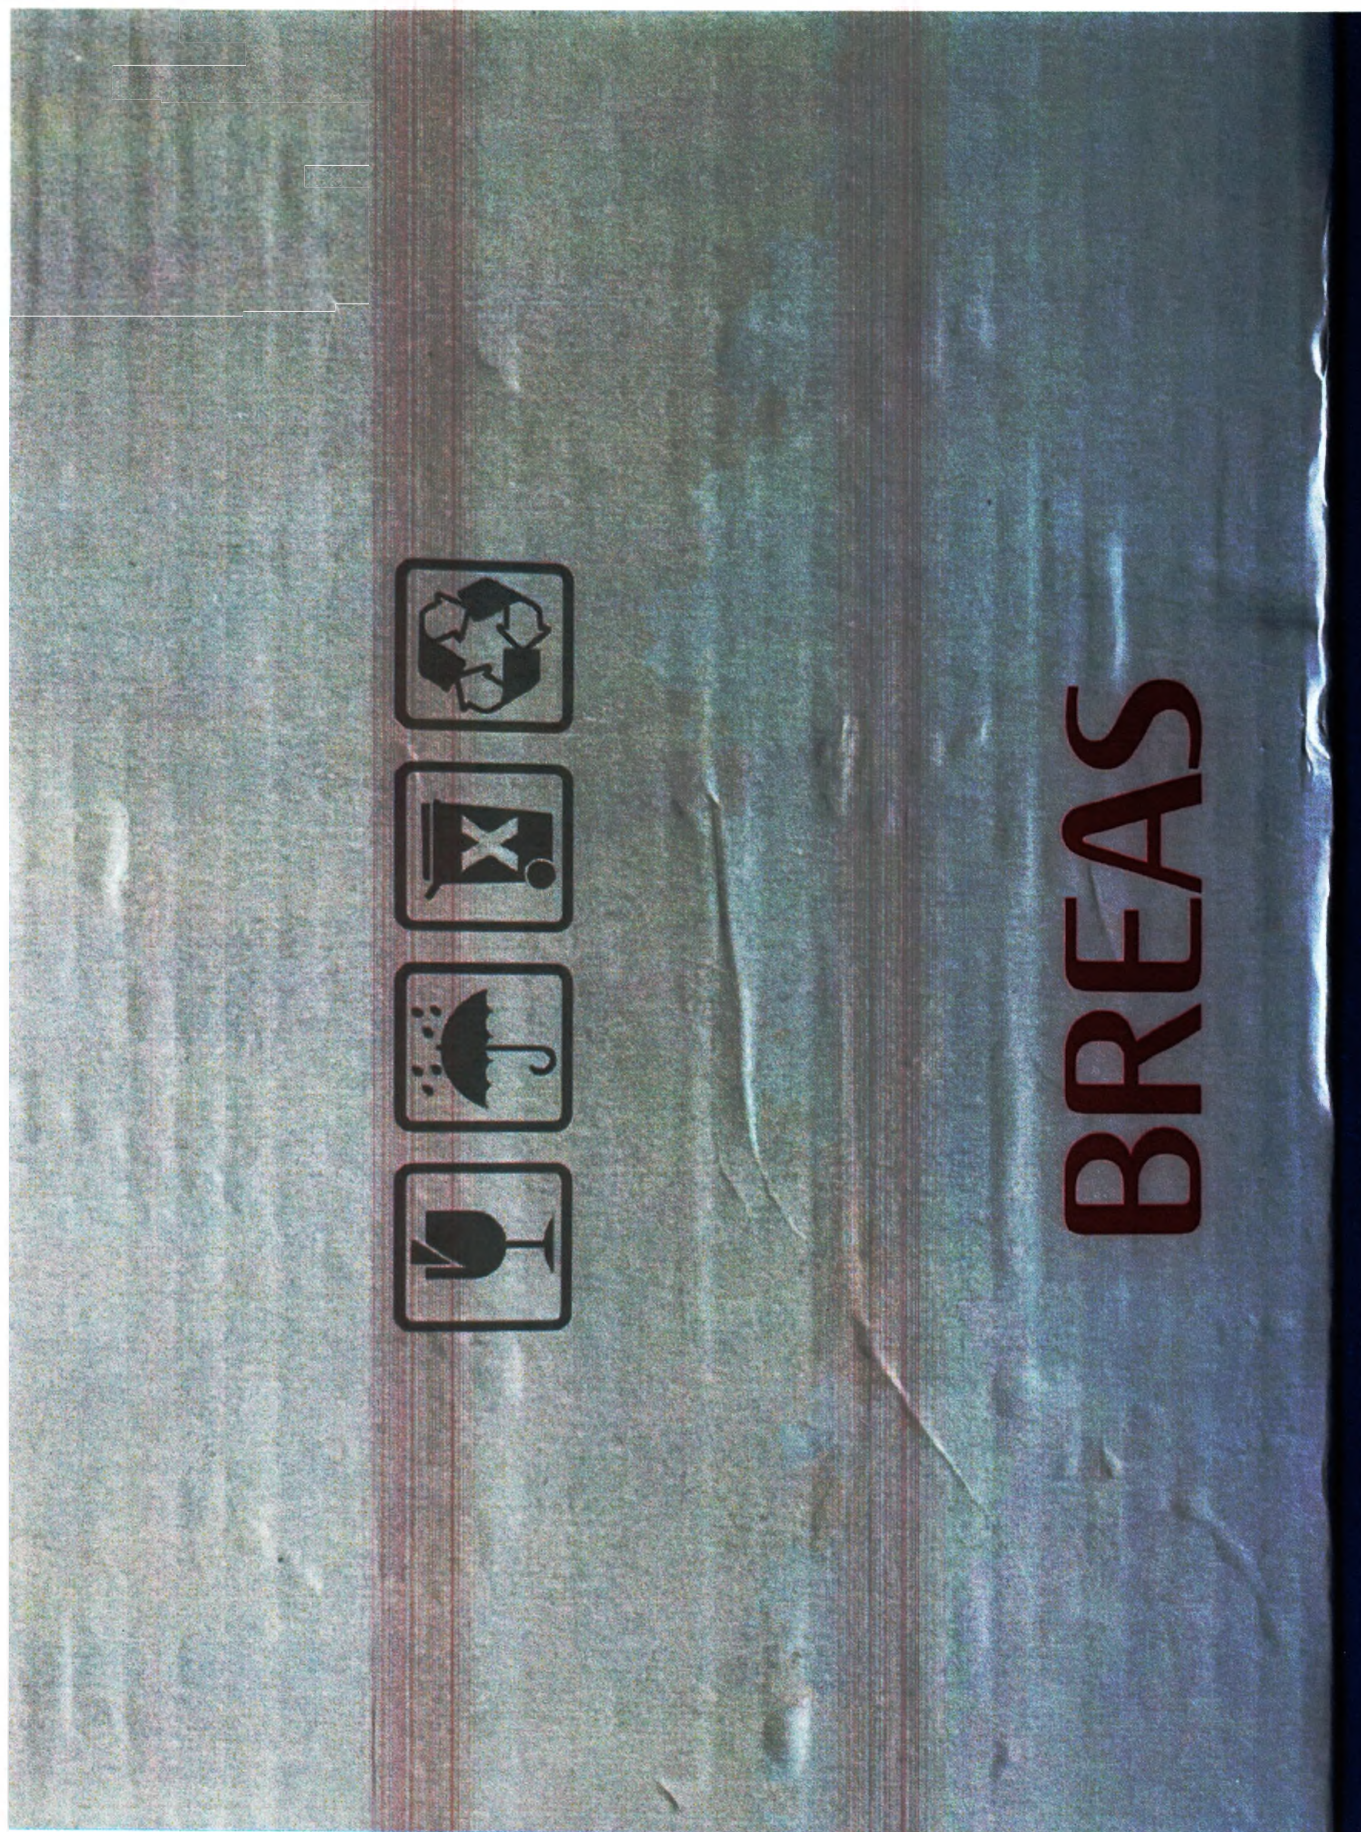

25. Кабель соединительный для батареи аккумуляторной внешней




26. Блок питания / подзарядки для батареи аккумуляторной внешней

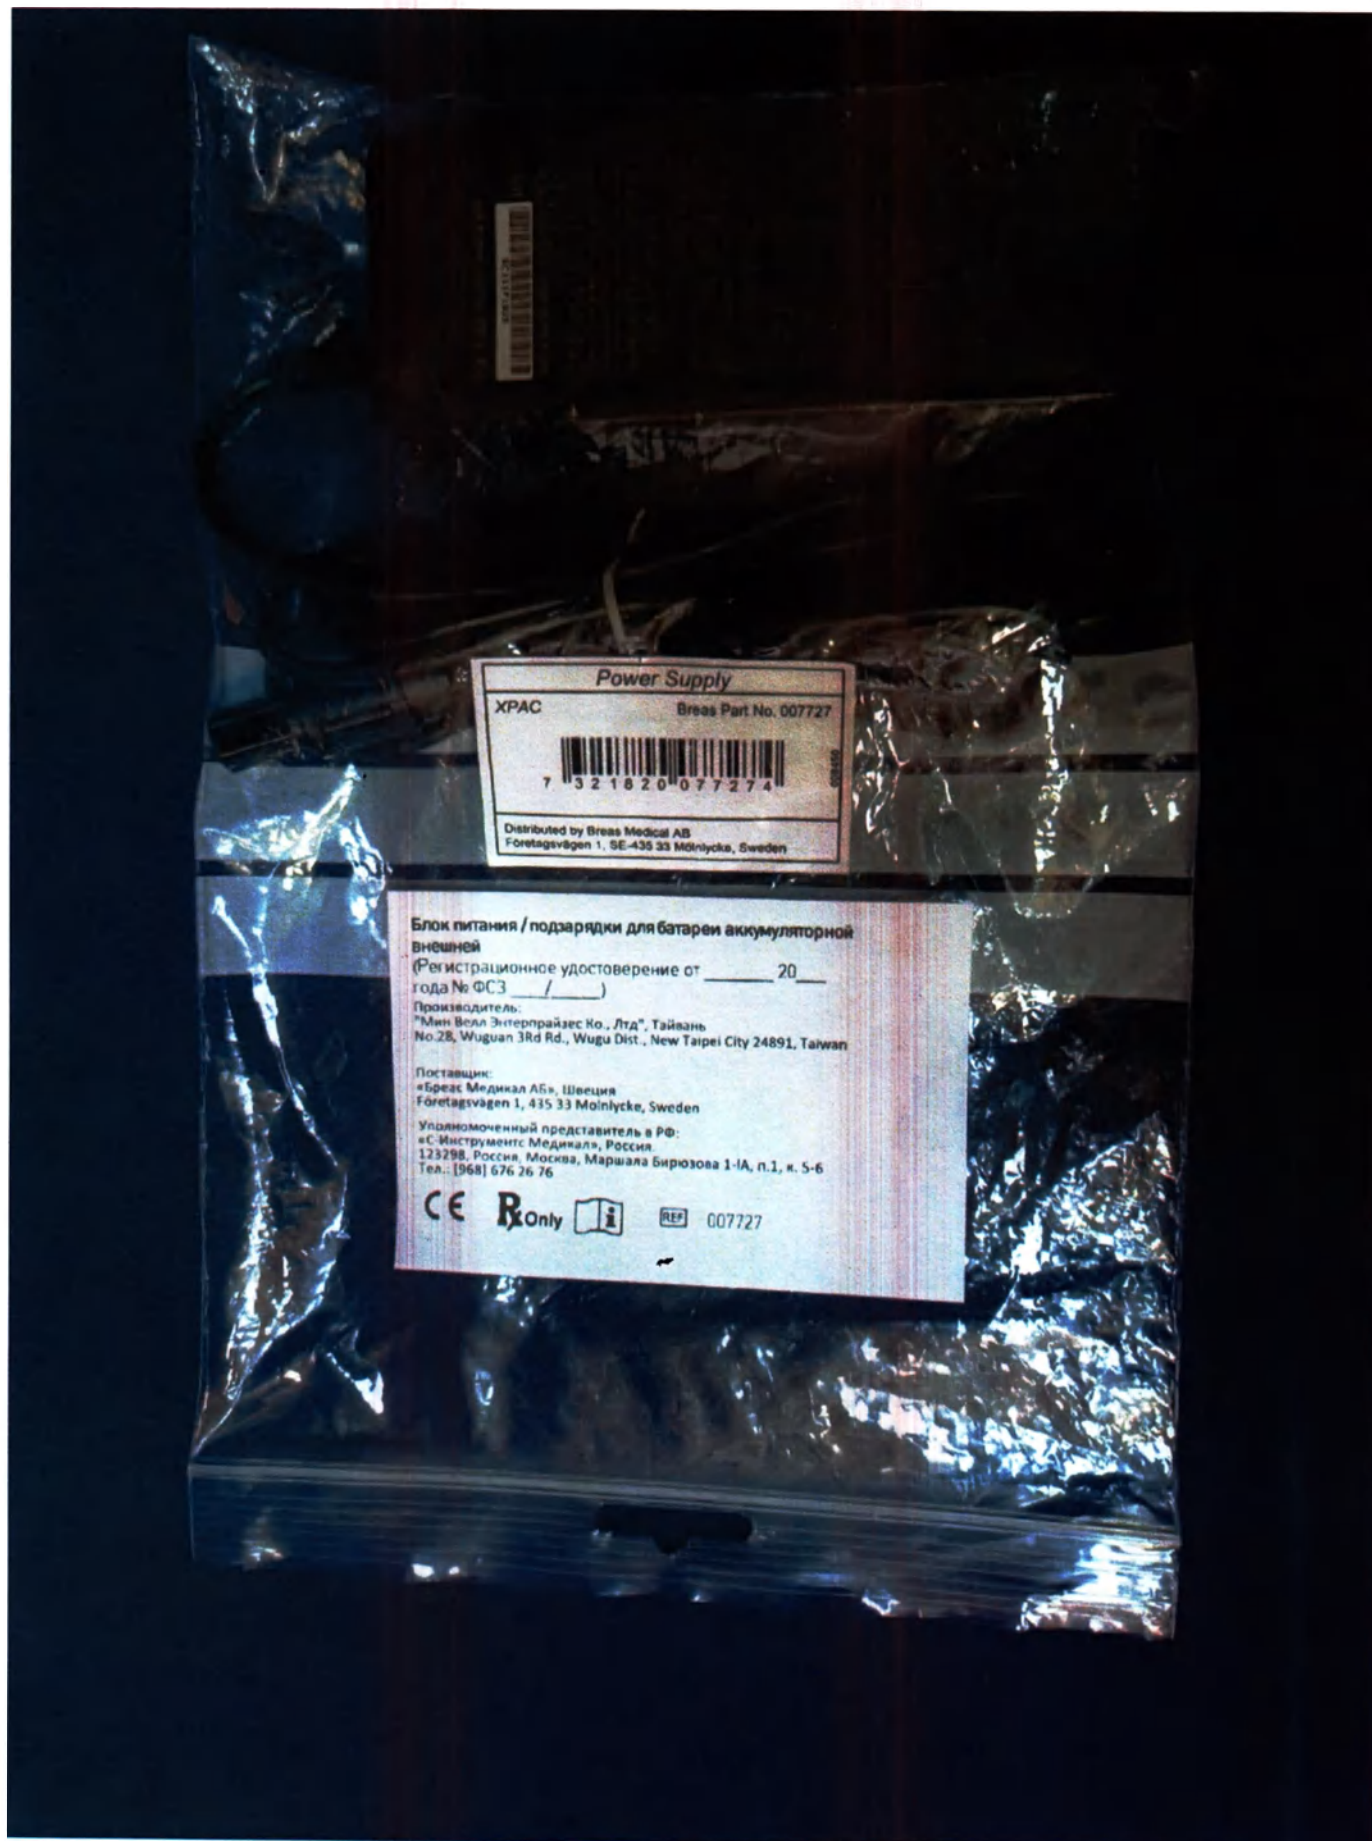



27. Монтажная стойка – продолжение

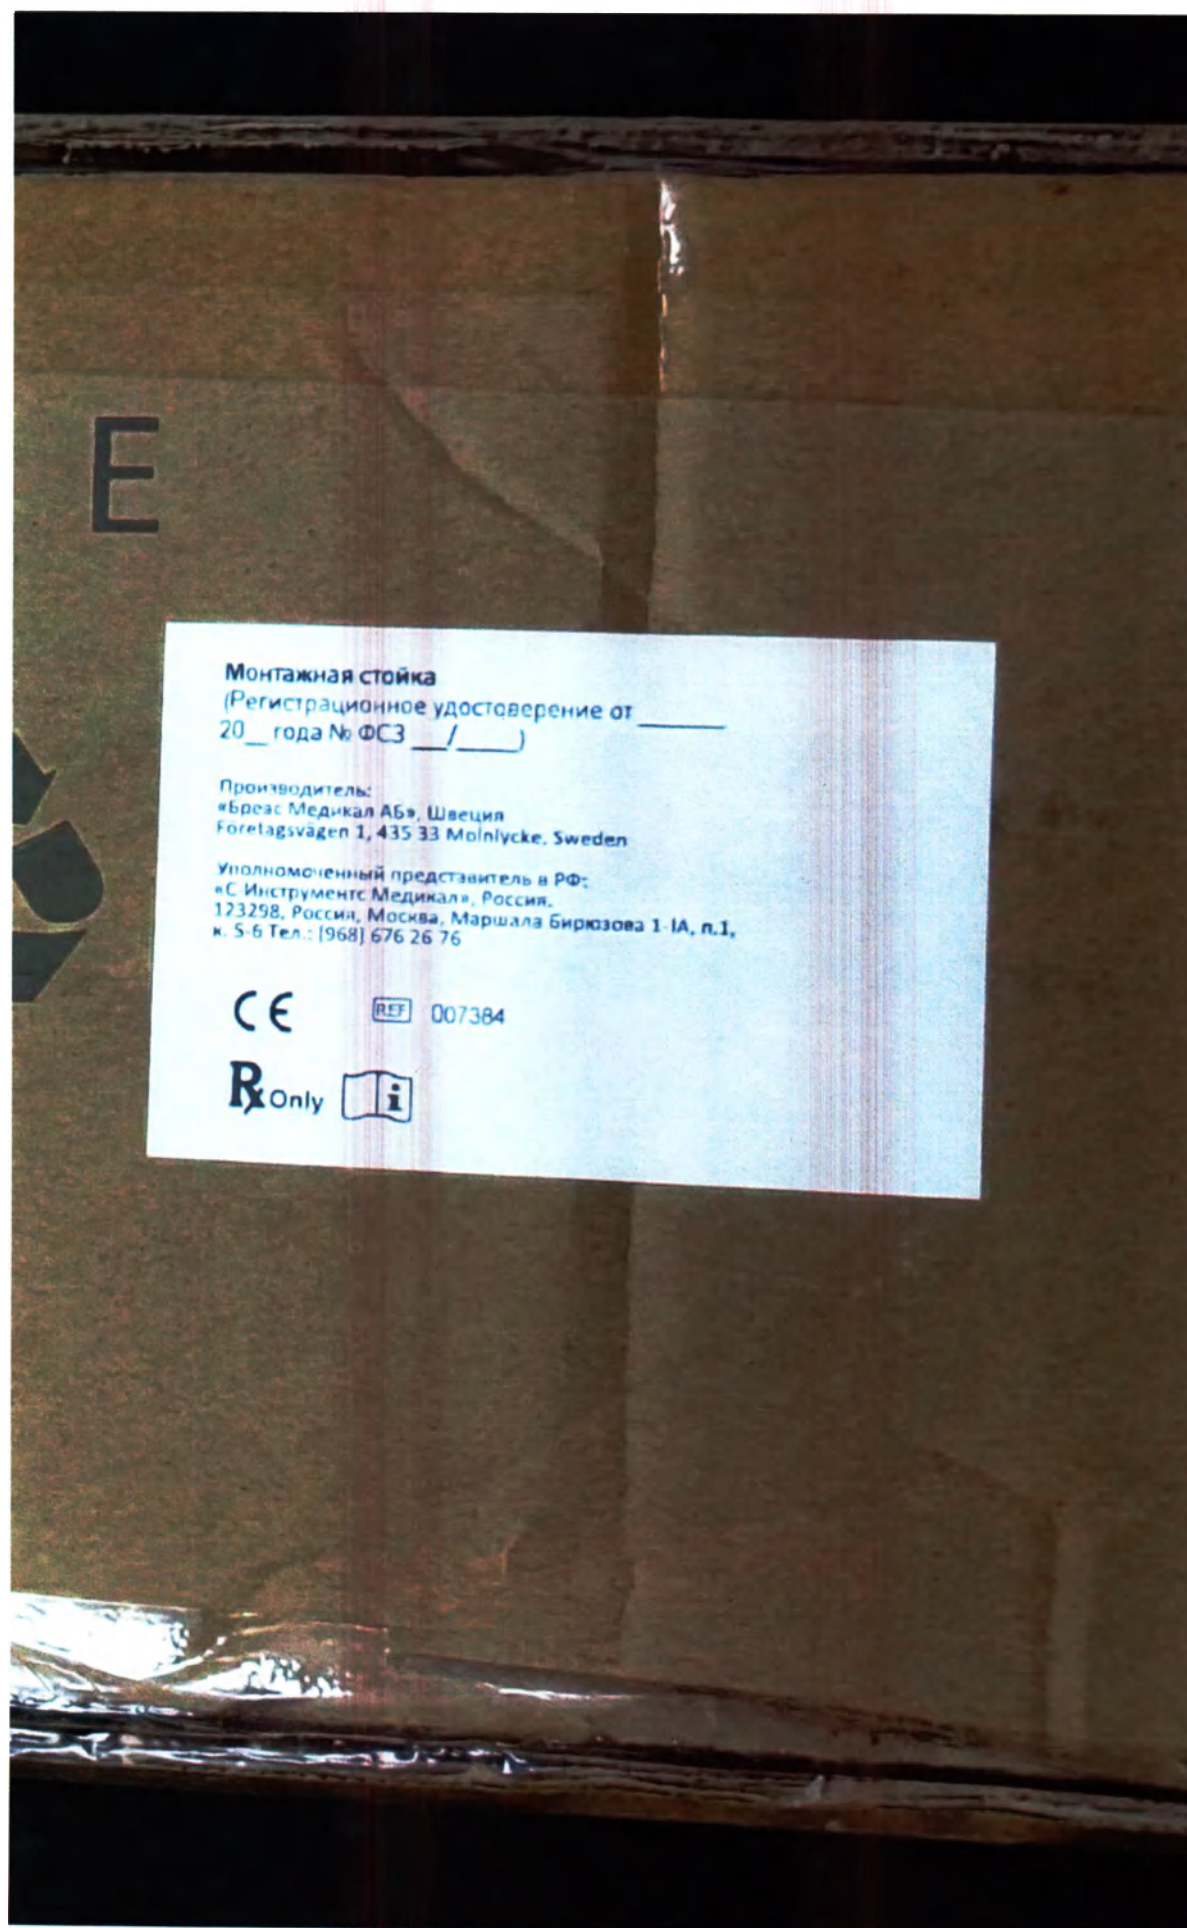

Монтажная стойка
(Регистрационное удостоверение от _____
20__ года № ФСЗ ____/____)

Производитель:
«Брегас Медикал АБ», Швеция
Foretagsvägen 1, 435 33 Molnlycke, Sweden


Уполномоченный представитель в РФ:
«С Инструментс Медикал», Россия,
123298, Россия, Москва, Маршала Бирюзова 1-1А, п.1,
к. 5-6 Тел.: [968] 676 26 76



007384

RxOnly



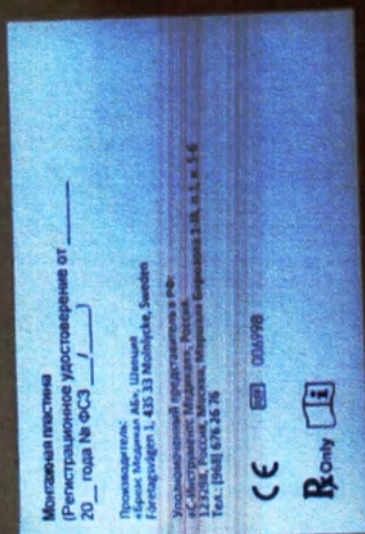

7 321820 079179

REF 007917

CE

128/100

MD

Arm för Patientcirkulär
Patient Circuit Arm
Schleuchthaltearm
Bras de circuit patient
Braccio circuito paziente
Brazo del circuito del paciente
Βραχίονας κυκλώματος ασθενούς
Potlasielkustion tukivarasi
Patientcirkulärsarm
Patiëntcircuitarm
Arm til slangesett
Ramie obwodni pacjenta
Brazo do circuito do paciente
Кронштейн контура
пациента
Ruka pacient creva
Hesta devresi kolu

BREAS
Breas Medical AB • Företagsvägen 1 • SE-435 33 Mölnlycke • Sweden

Кронштейн контура пациента
(Регистрационное удостоверение от _____ 20____
года № ФСЗ ____/____)


Производитель:
«Бреас Медикал АБ», Швеция
Företagsvägen 1, 435 33 Mölnlycke, Sweden

Уполномоченный представитель в РФ:
«С-Инструментс Медикал», Россия.
123298, Россия, Москва, Маршала Бирюзова 14А, п.1, к. 5-6
Тел.: [968] 676 26 76

CE REF 007917

Rx Only  

30. Зажим для крепления, универсальный

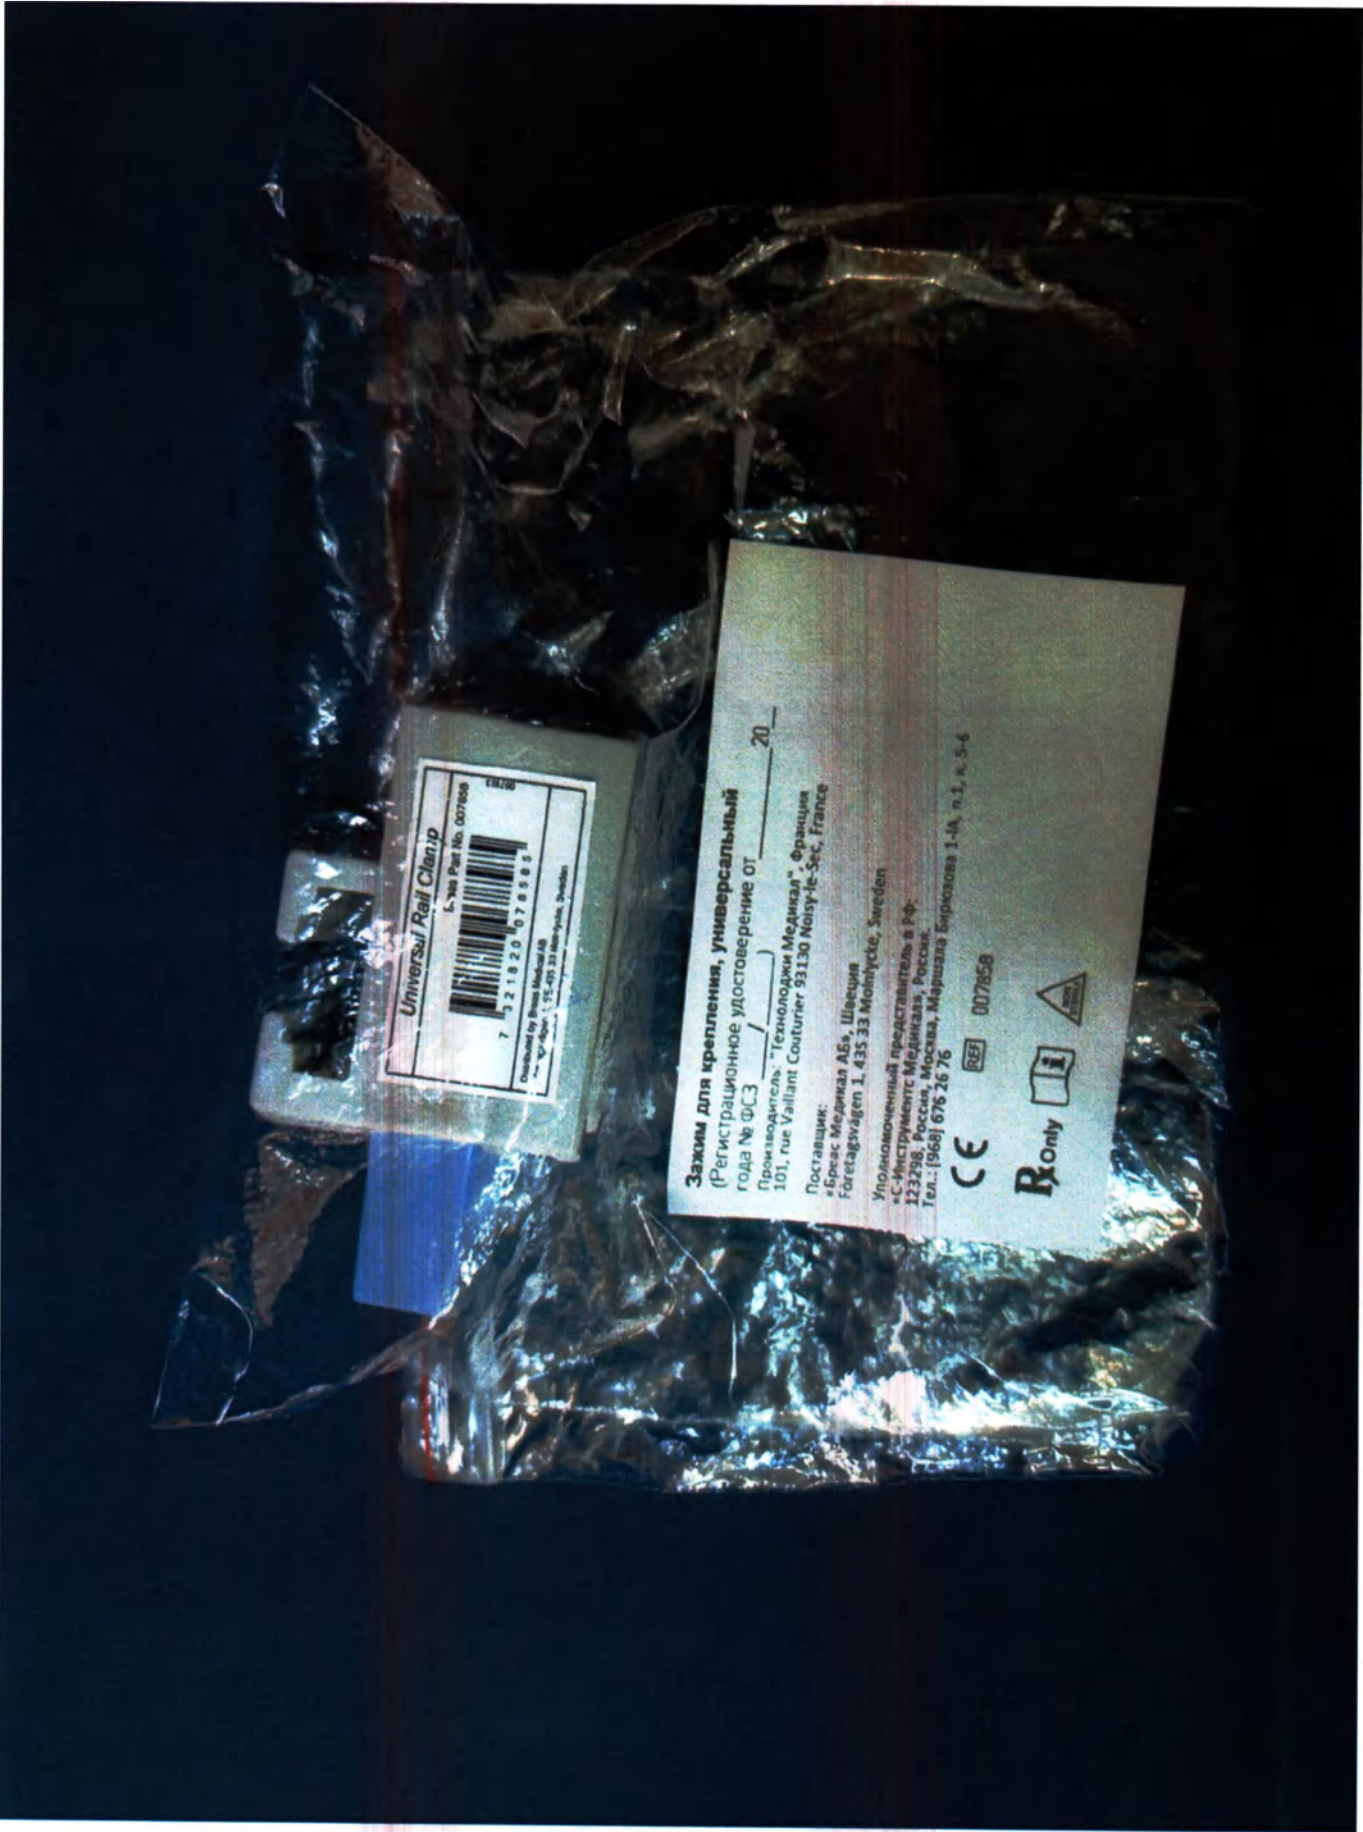

31. Держатель универсальный





Держатель универсальный
(Регистрационное удостоверение от _____
20__ года № ФСЗ ____/____)

Производитель:
«Бреас Медикал АБ», Швеция
Företagsvägen 1, 435 33 Mölnlycke, Sweden

Уполномоченный представитель в РФ:
«С-Инструментс Медикал», Россия.
123298, Россия, Москва, Маршала Бирюзова 1-1А, п.1, к. 5-6
Тел.: [968] 676 26 76




REF 007859

Rx Only



32. Колба увлажнителя

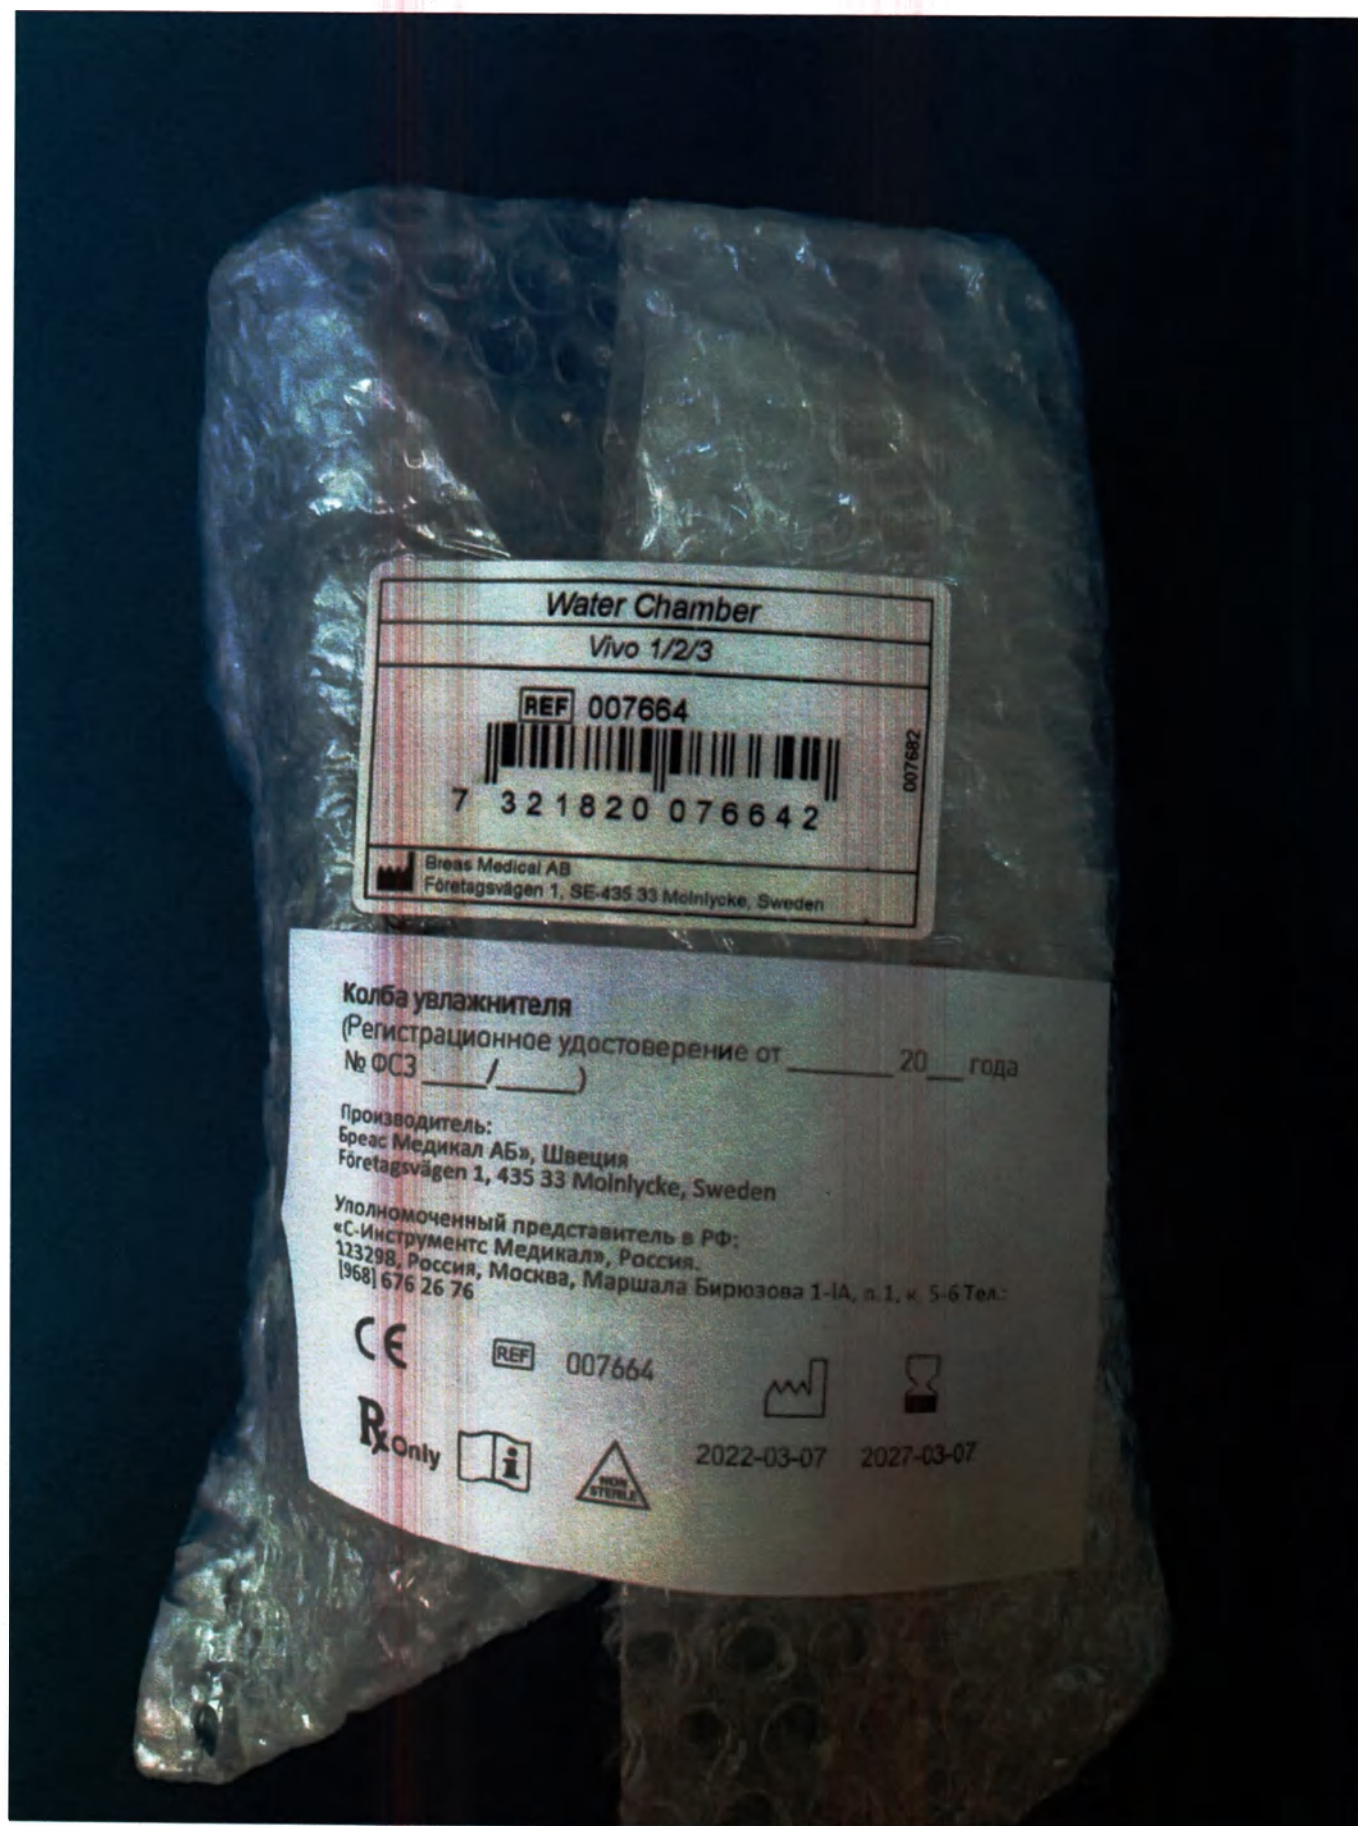


33. Картридж нагревательный для увлажнителя



34. Сумка транспортная батареи аккумуляторной внешней



35. Защитный кейс

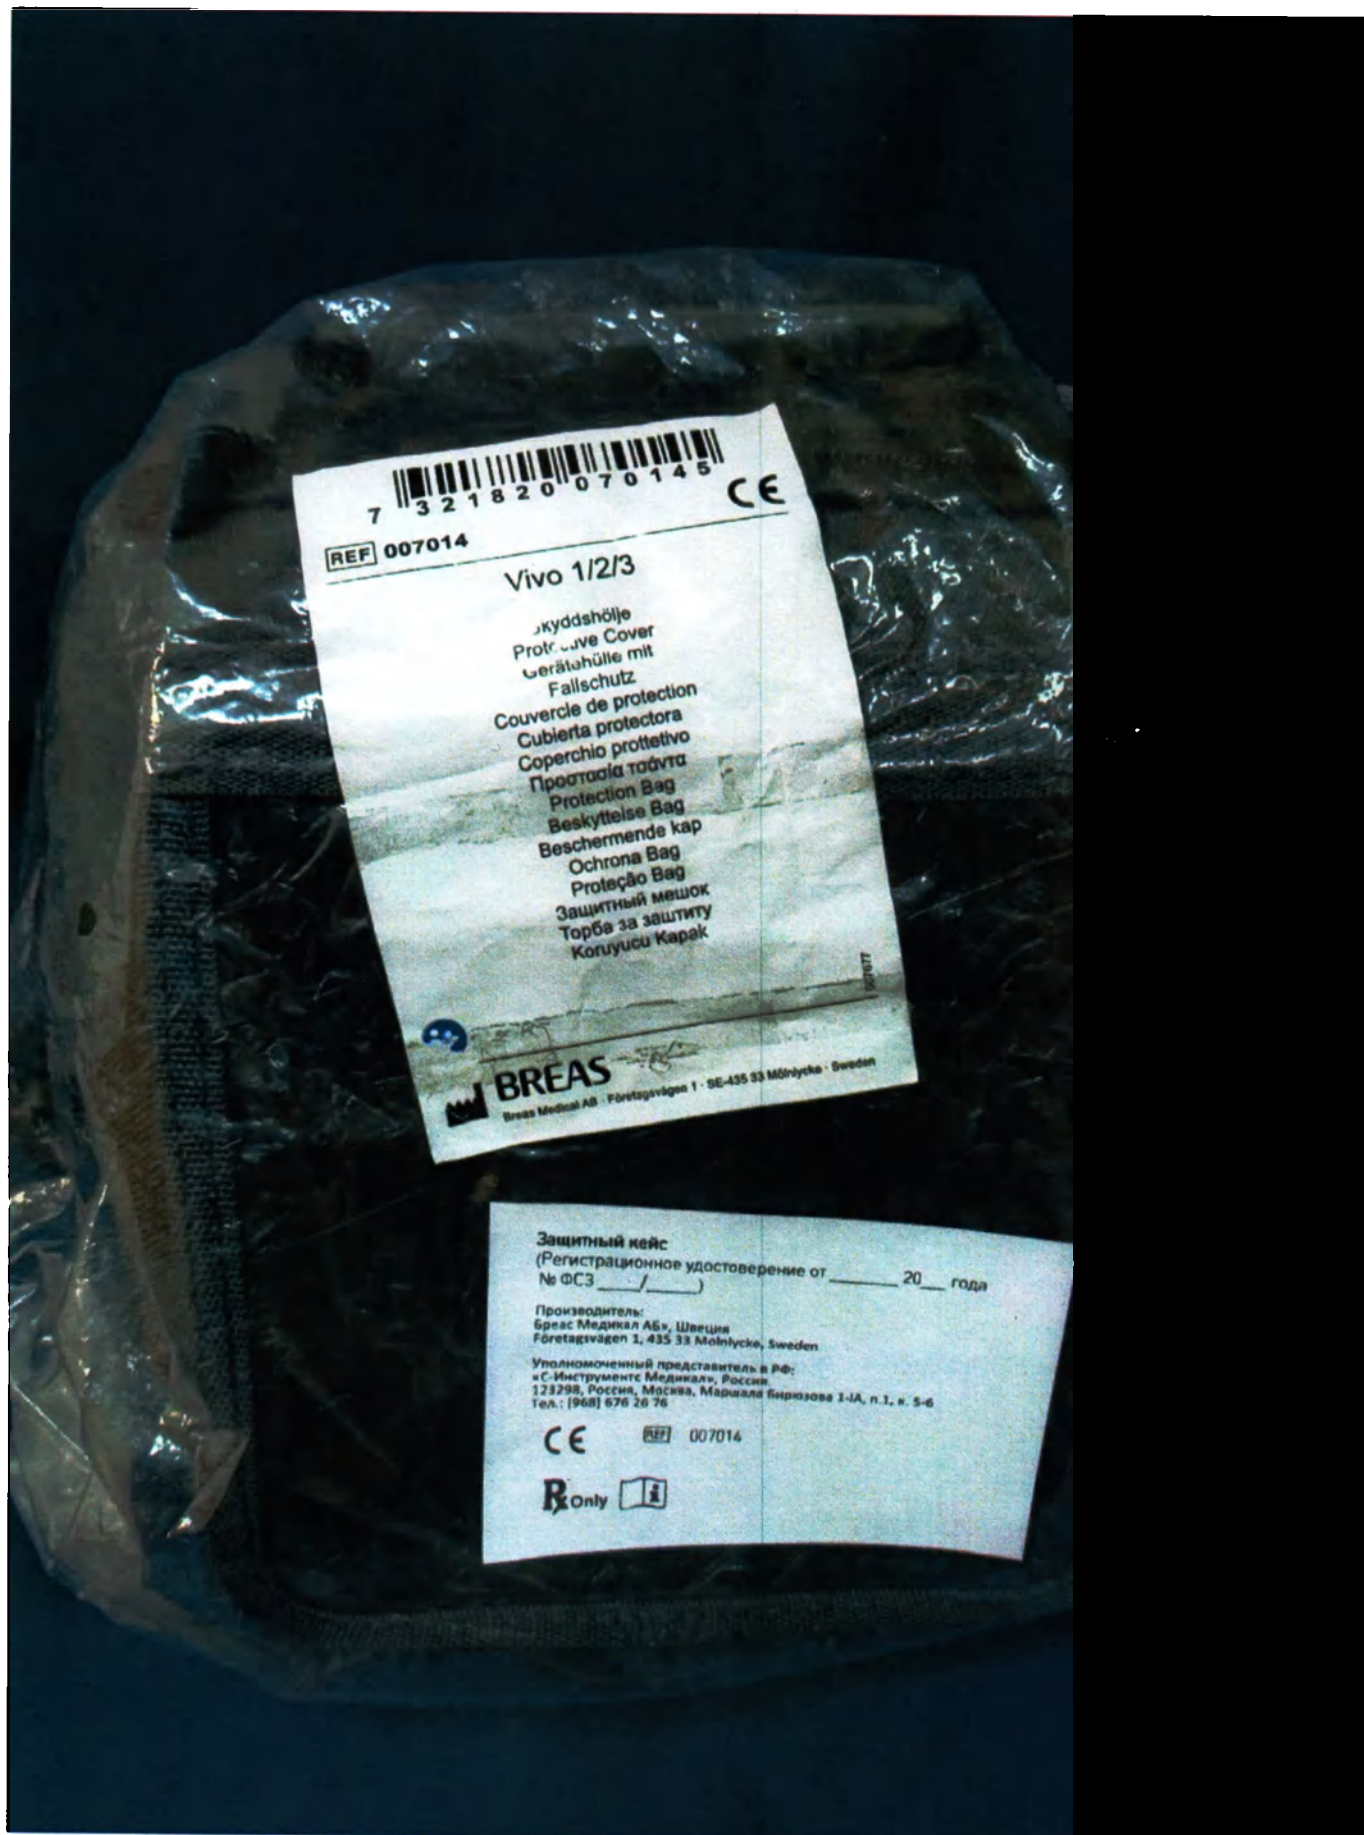

36. Лёгкая транспортная сумка



36. Лёгкая транспортная сумка - продолжение



Фотографические изображения транспортной упаковки комплекта поставки на примере варианта исполнения Vivo 3 (одинаково для всех вариантов исполнений).







Фотографические изображения маркировки транспортной упаковки комплекта поставки изделия.



52032

Vivo 1 SE

REF 227001

SO# 22001217

SN M130434



(01)07321822270017(21)M130434

Breas Medical AB
Företagsvägen 1, 43533 Mölnlycke, Sweden



Storage and
transport temp.
-20°C to +60°C
Humidity <95%

BREAS

Breas Medical AB. Företagsv 1, SE-435 33 Mölnlycke, Sweden

42012

Vivo 2 SE

REF

228001

SO#

22001217

SN

M130445



(01)07321822280016(21)M130445

Breas Medical AB

Företagsvägen 1, 435 33 Mölnlycke, Sweden

FROM HOSPITAL
TO HOME

BREAS



Storage and
transport temp.
-20°C to +60°C

Humidity <95%

BREAS

Breas Medical AB. Företagsv 1, SE-435 33 Mölnlycke, Sweden

Vivo 3 SE

REF

229001

SO#

22001217

SN

M140559



(01)07321822290015(21)M140559

Breas Medical AB

Företagsvägen 1, 43533 Mölnlycke, Sweden



UN3481

For more information, call +46 31 868800



Storage and
transport temp.
-20°C to +60°C

Humidity <95%

BREAS

Breas Medical AB. Företagsv 1, SE-435 33 Mölnlycke, Sweden

Пример фотографических изображений транспортной упаковки составных частей изделия с маркировкой (одинаково для всех вариантов исполнений).







Storage and
transport temp
-20°C to +25°C
Humidity 45-65%

AS

FROM
TO HQ

Breas Medical AB. Företagsväg 435 33 Mölnlycke, Sweden

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
73 (семьдесят три) листа

Генеральный директор
ООО «С-Инструментс Медикал»


Д. В. Соколов



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «С-Инструментс Медикал»
Д.В. Соколов



(подпись)

«21» июня 2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия


Аппарат искусственной вентиляции легких серии Vivo, вариант исполнения Vivo 1.

1. Аппарат искусственной вентиляции легких, вариант исполнения Vivo 1, в составе: 1. Блок аппарата базовый Vivo 1.







3. Держатель фильтров.

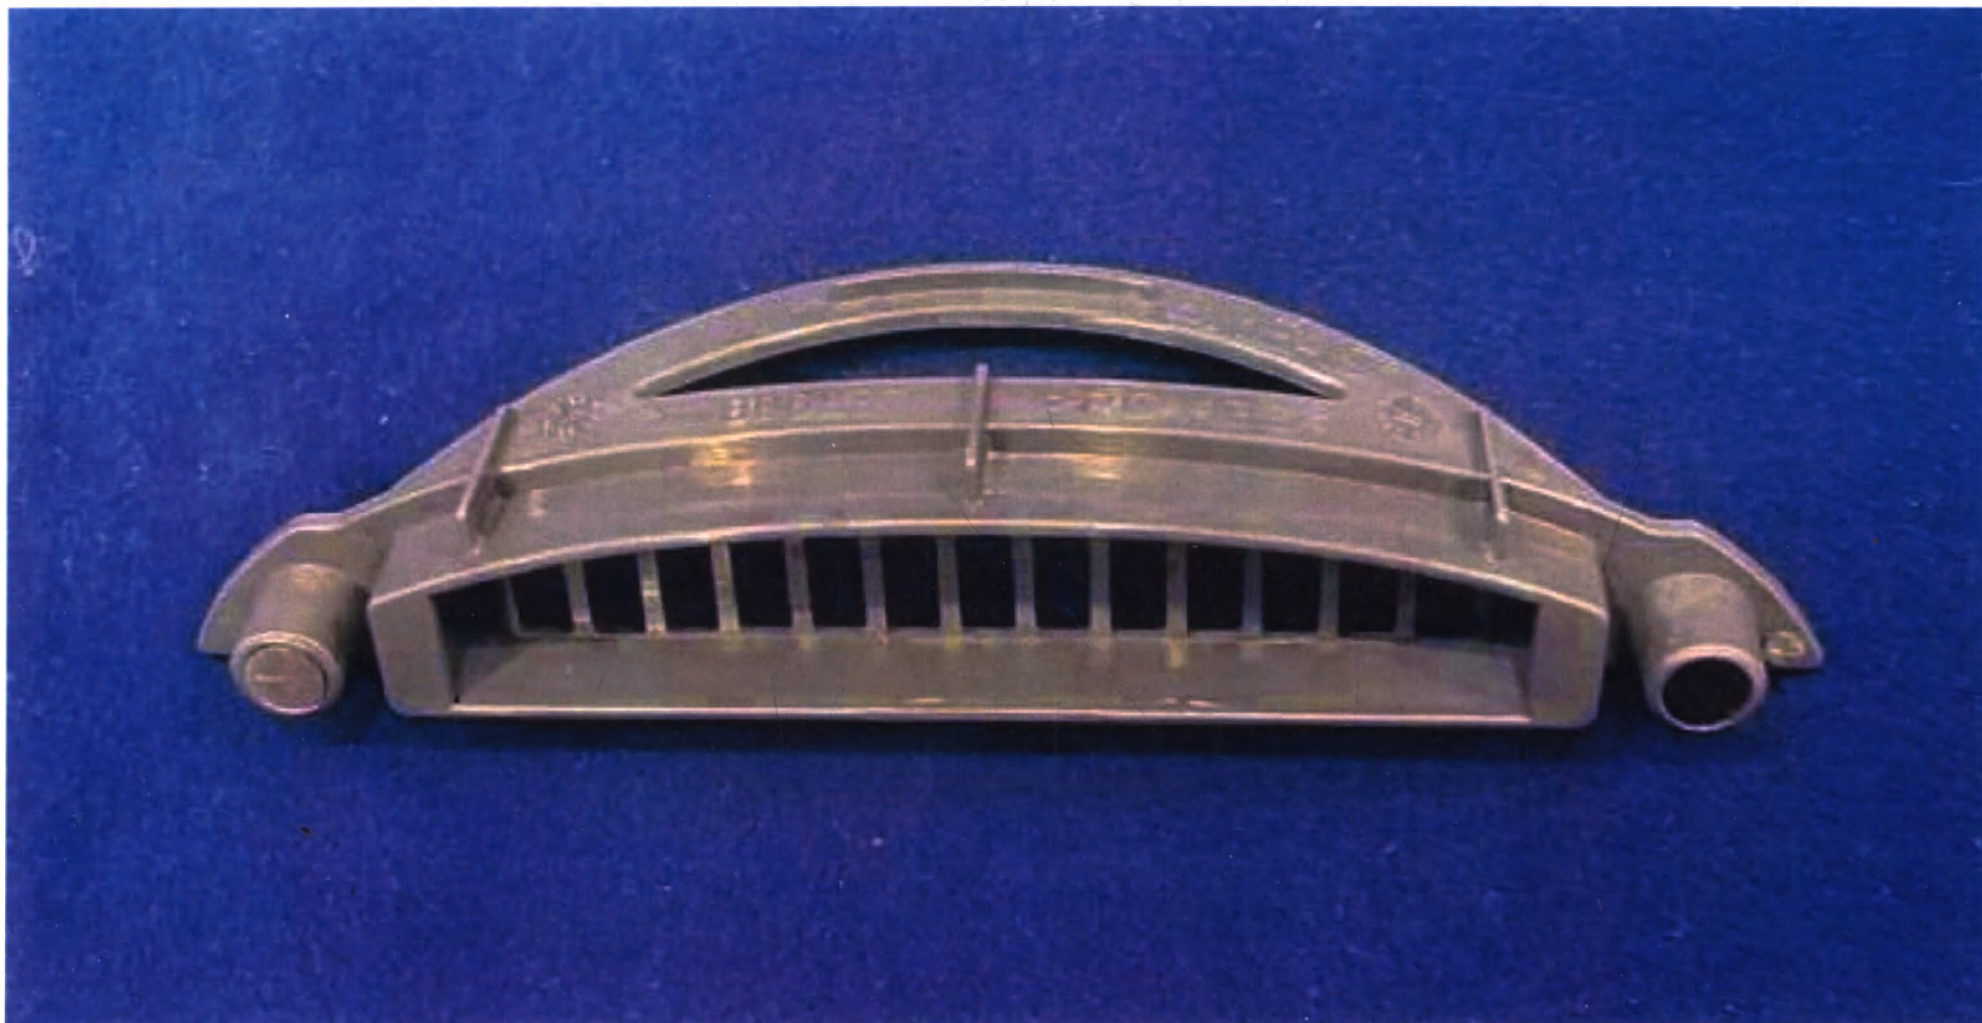


4. Фильтр воздухозаборного отверстия, грубой очистки.

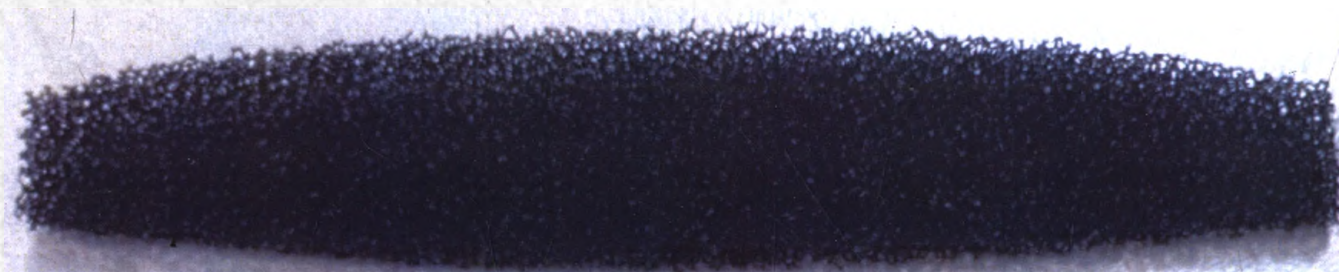


5. Фильтр воздухозаборного отверстия, тонкой очистки.

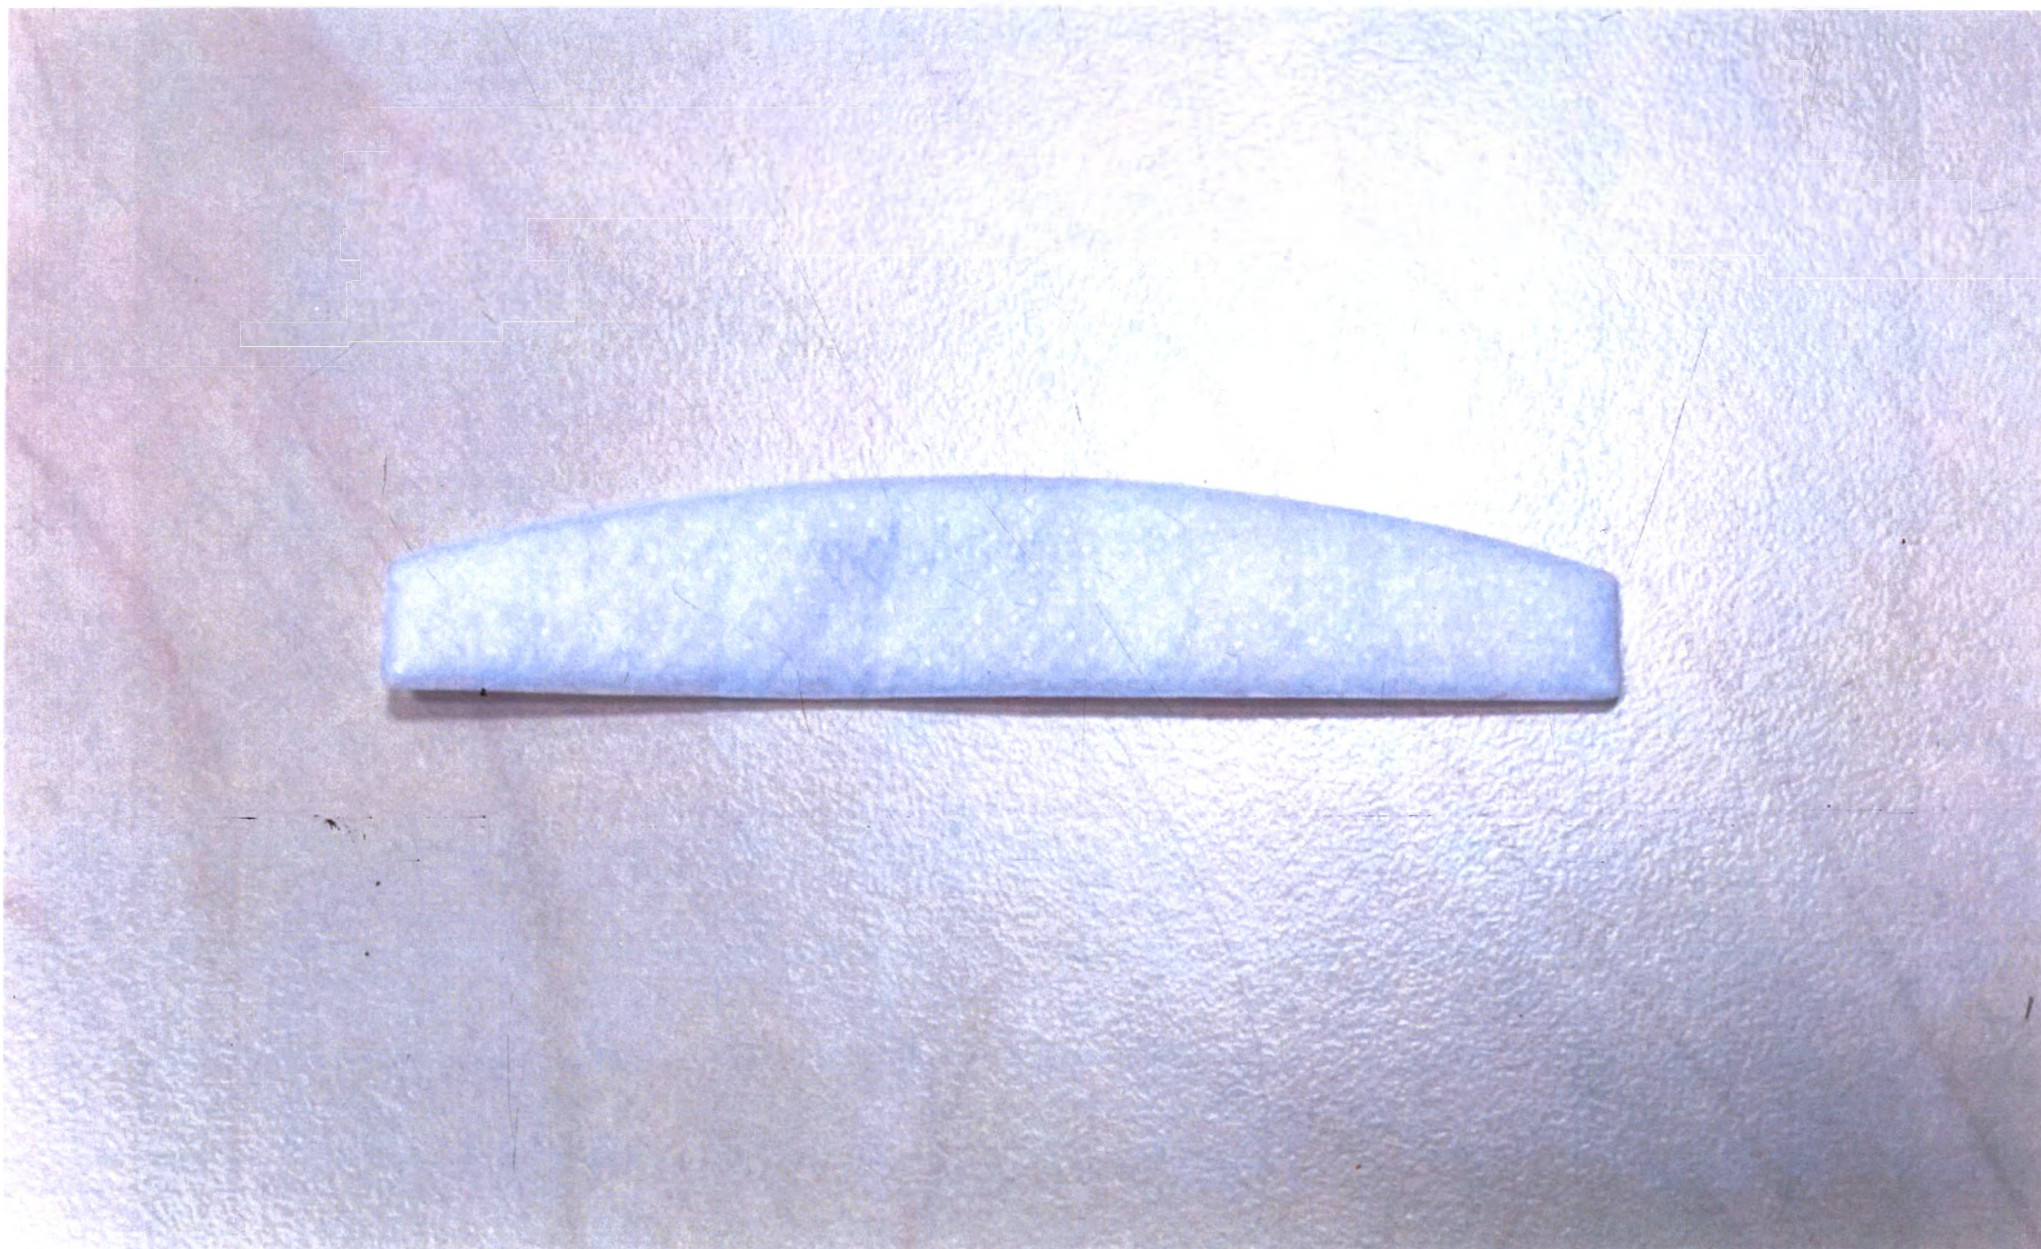

6. Адаптер питания AC/DC.

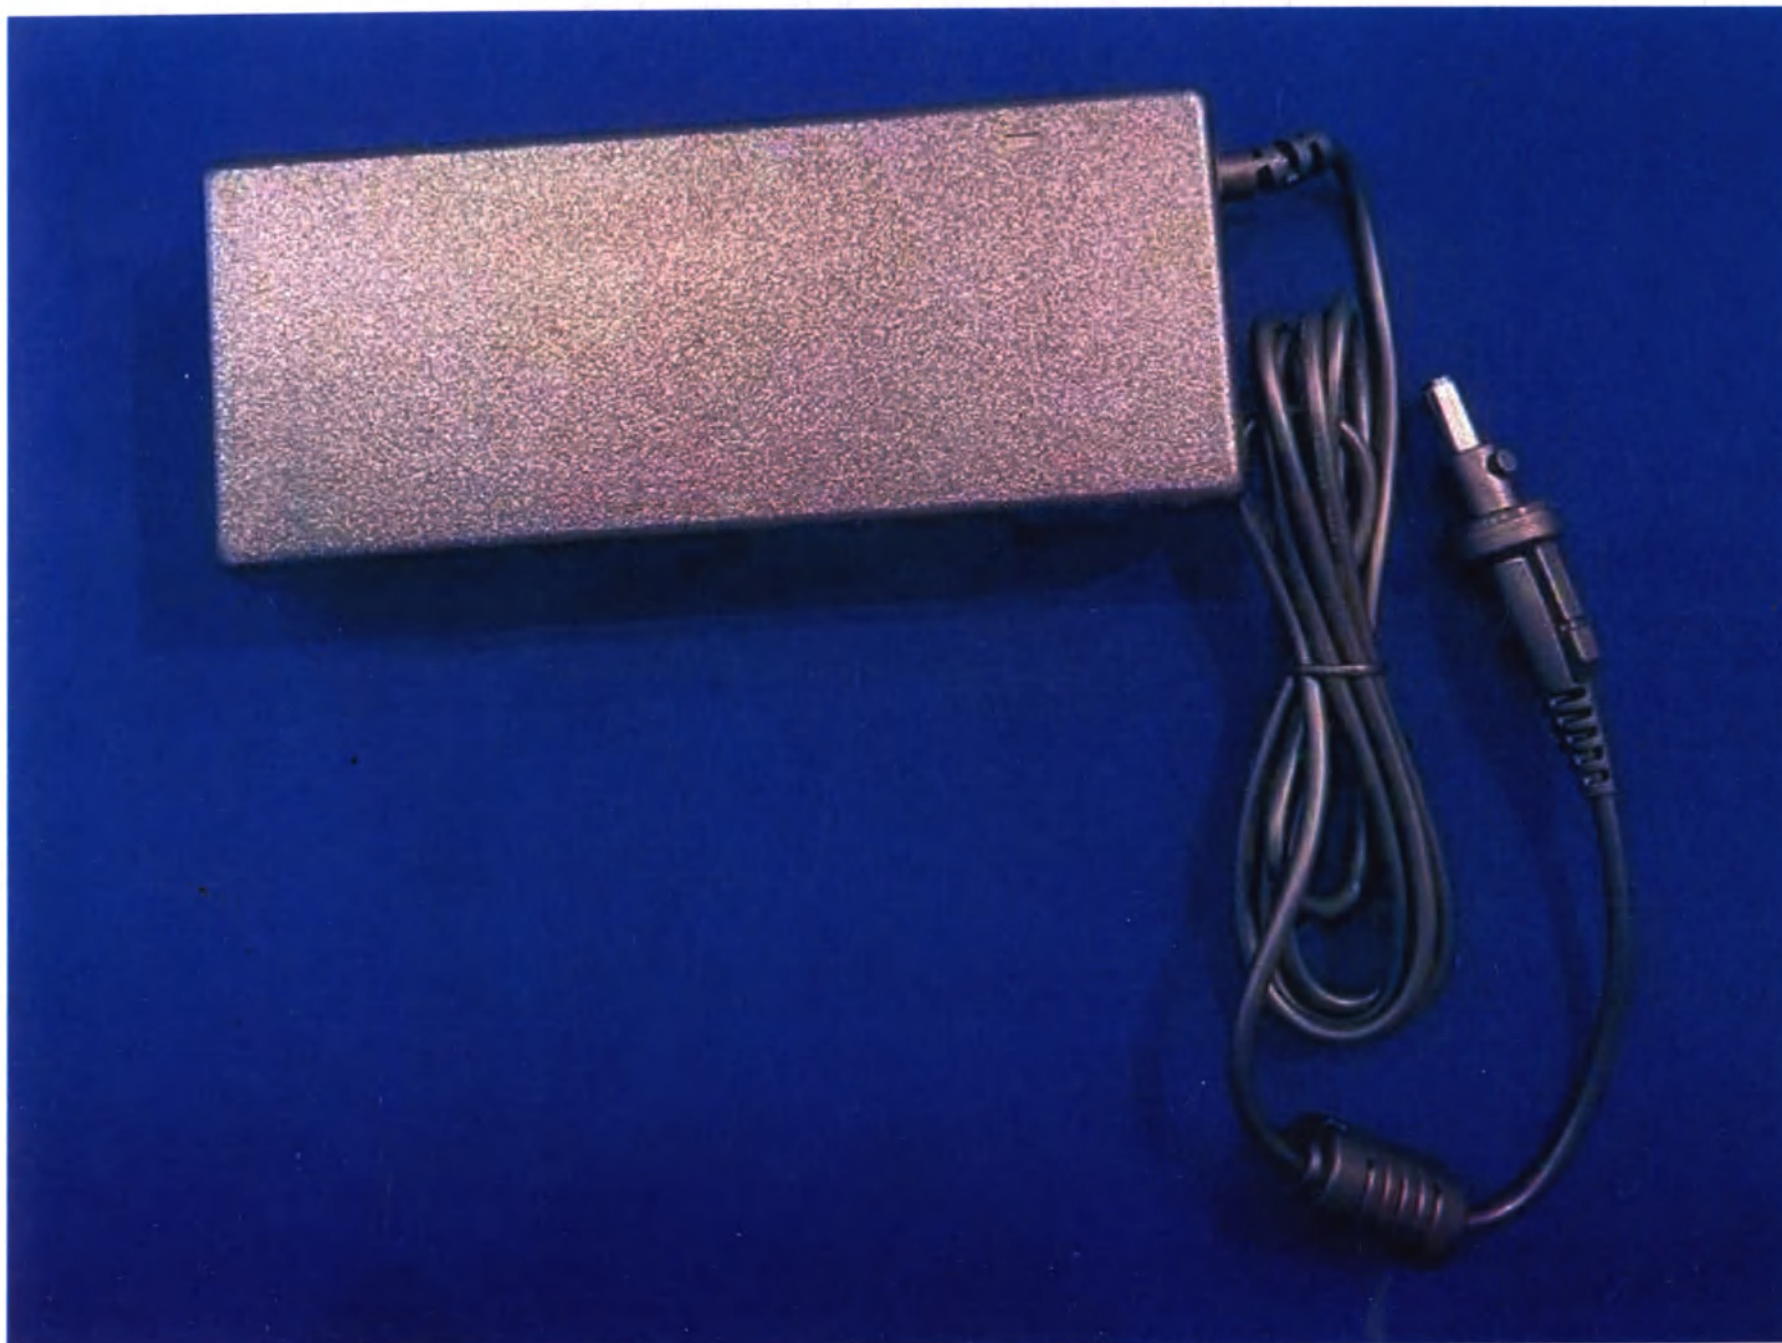

7. Кабель сетевой.

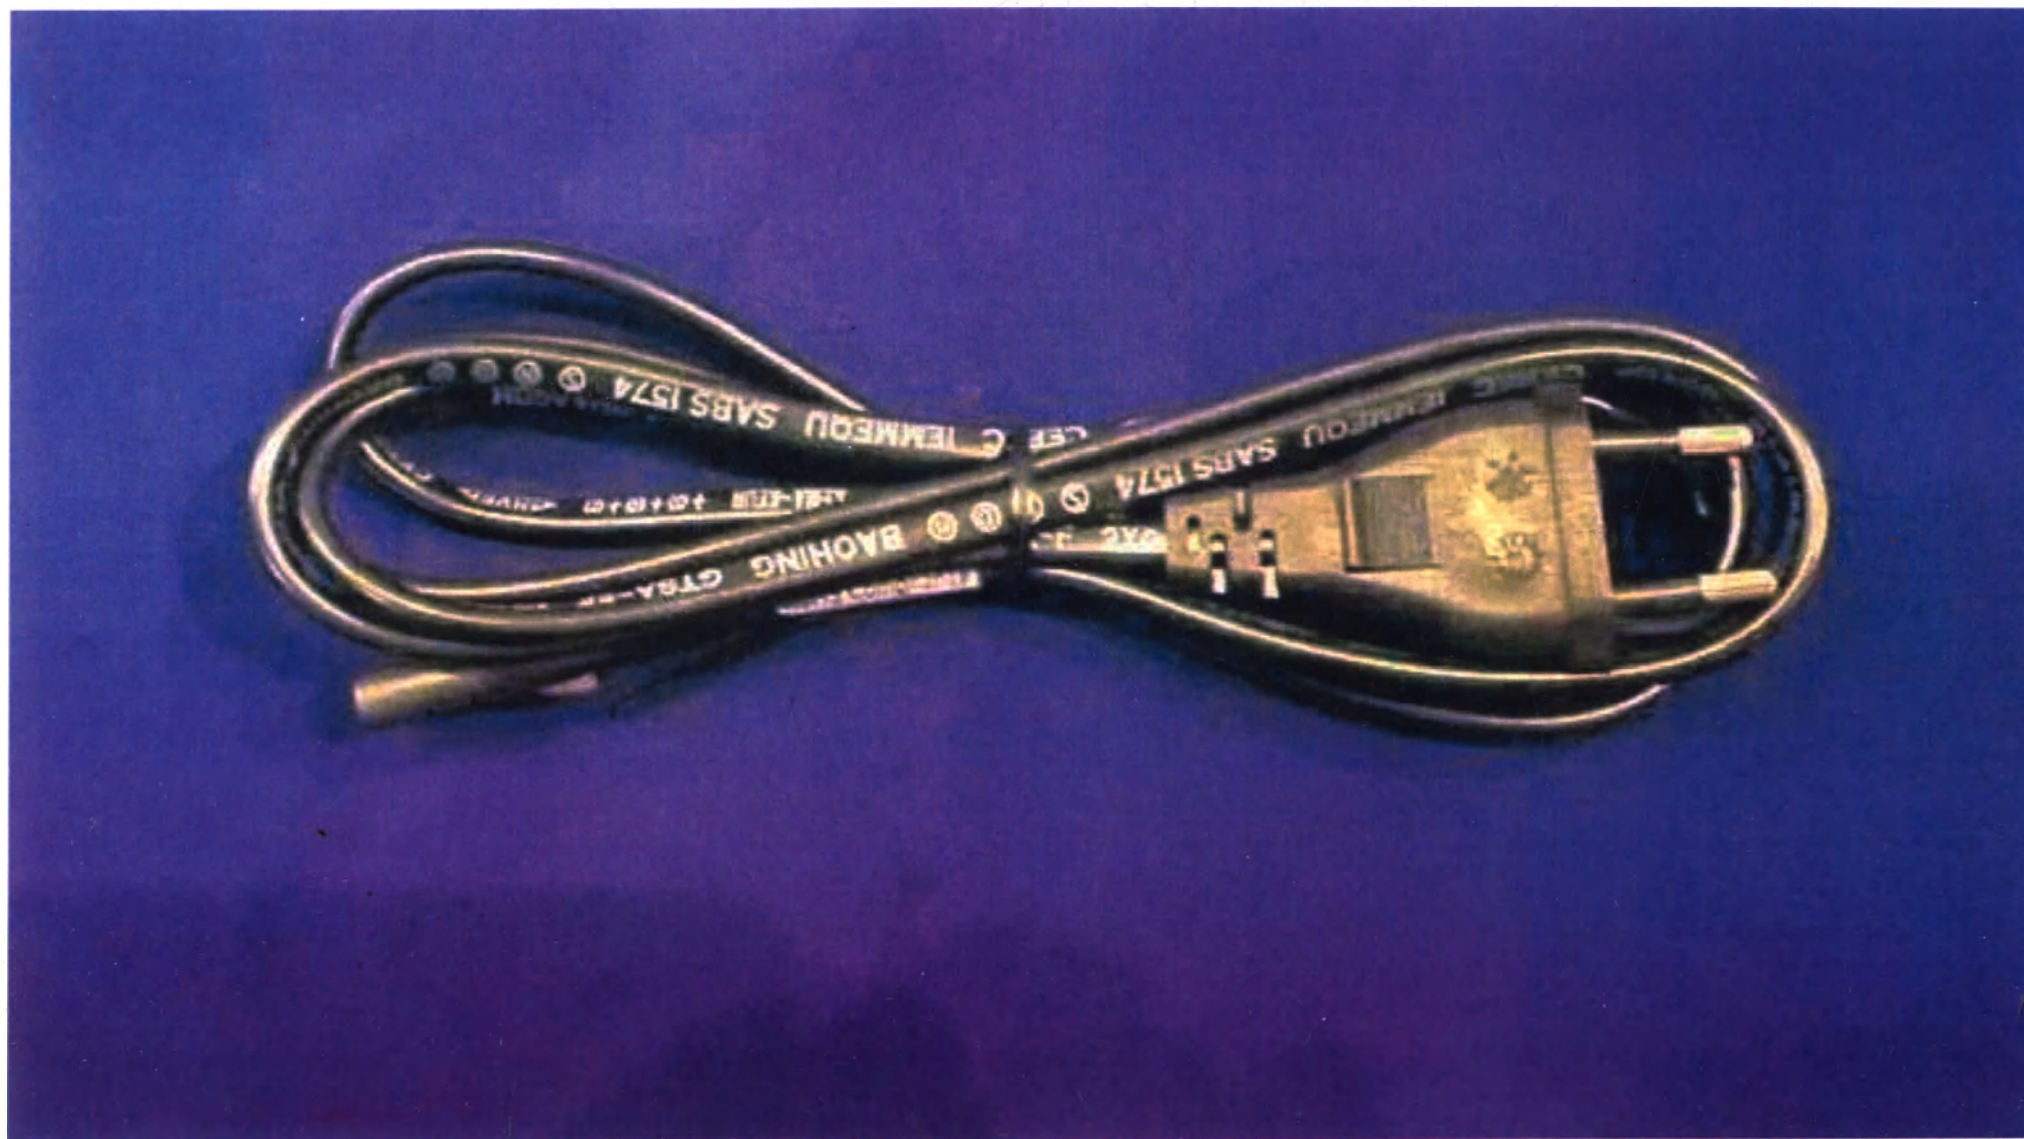


8. Штуцер кислорода низкого давления.



9. Сумка для транспортировки.




10. Контур пациента односоставной диаметром 15 мм, индивидуальный.

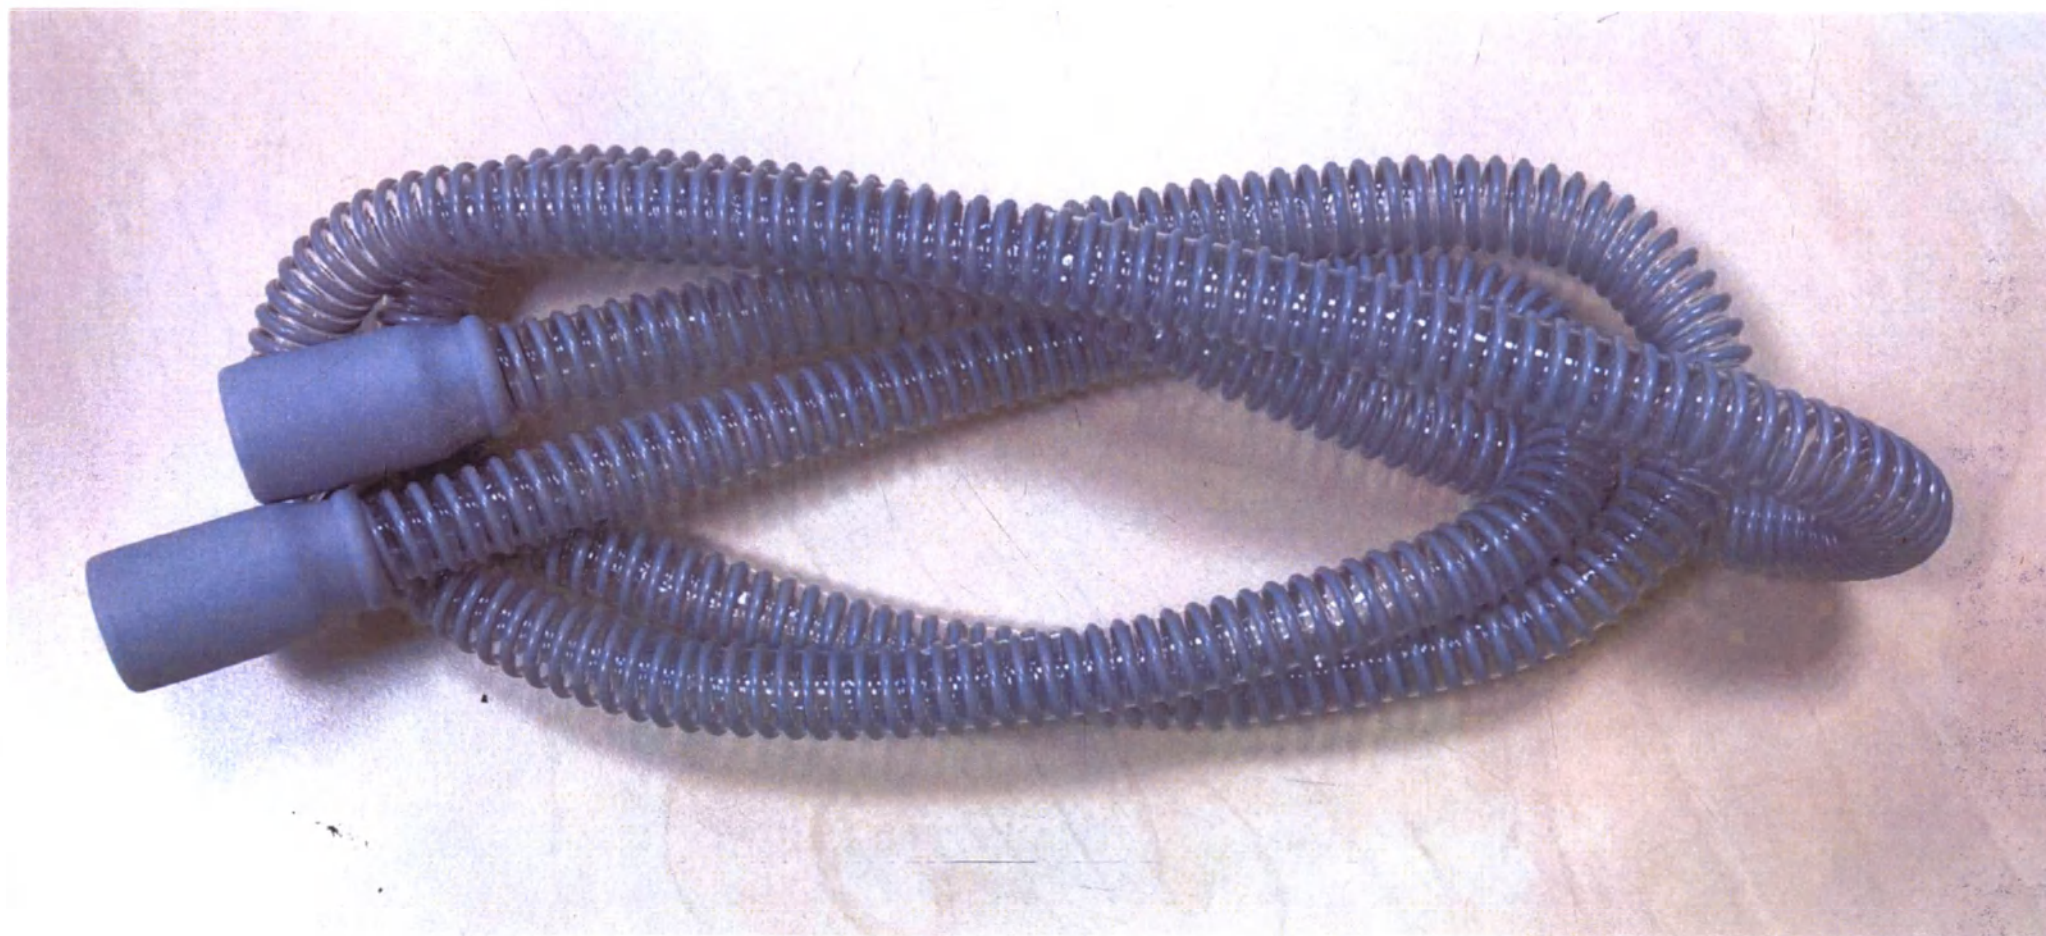


11. Контур пациента одноставной диаметром 22 мм, индивидуальный.




12. Контур пациента односоставной диаметром 15 мм, подогреваемый.

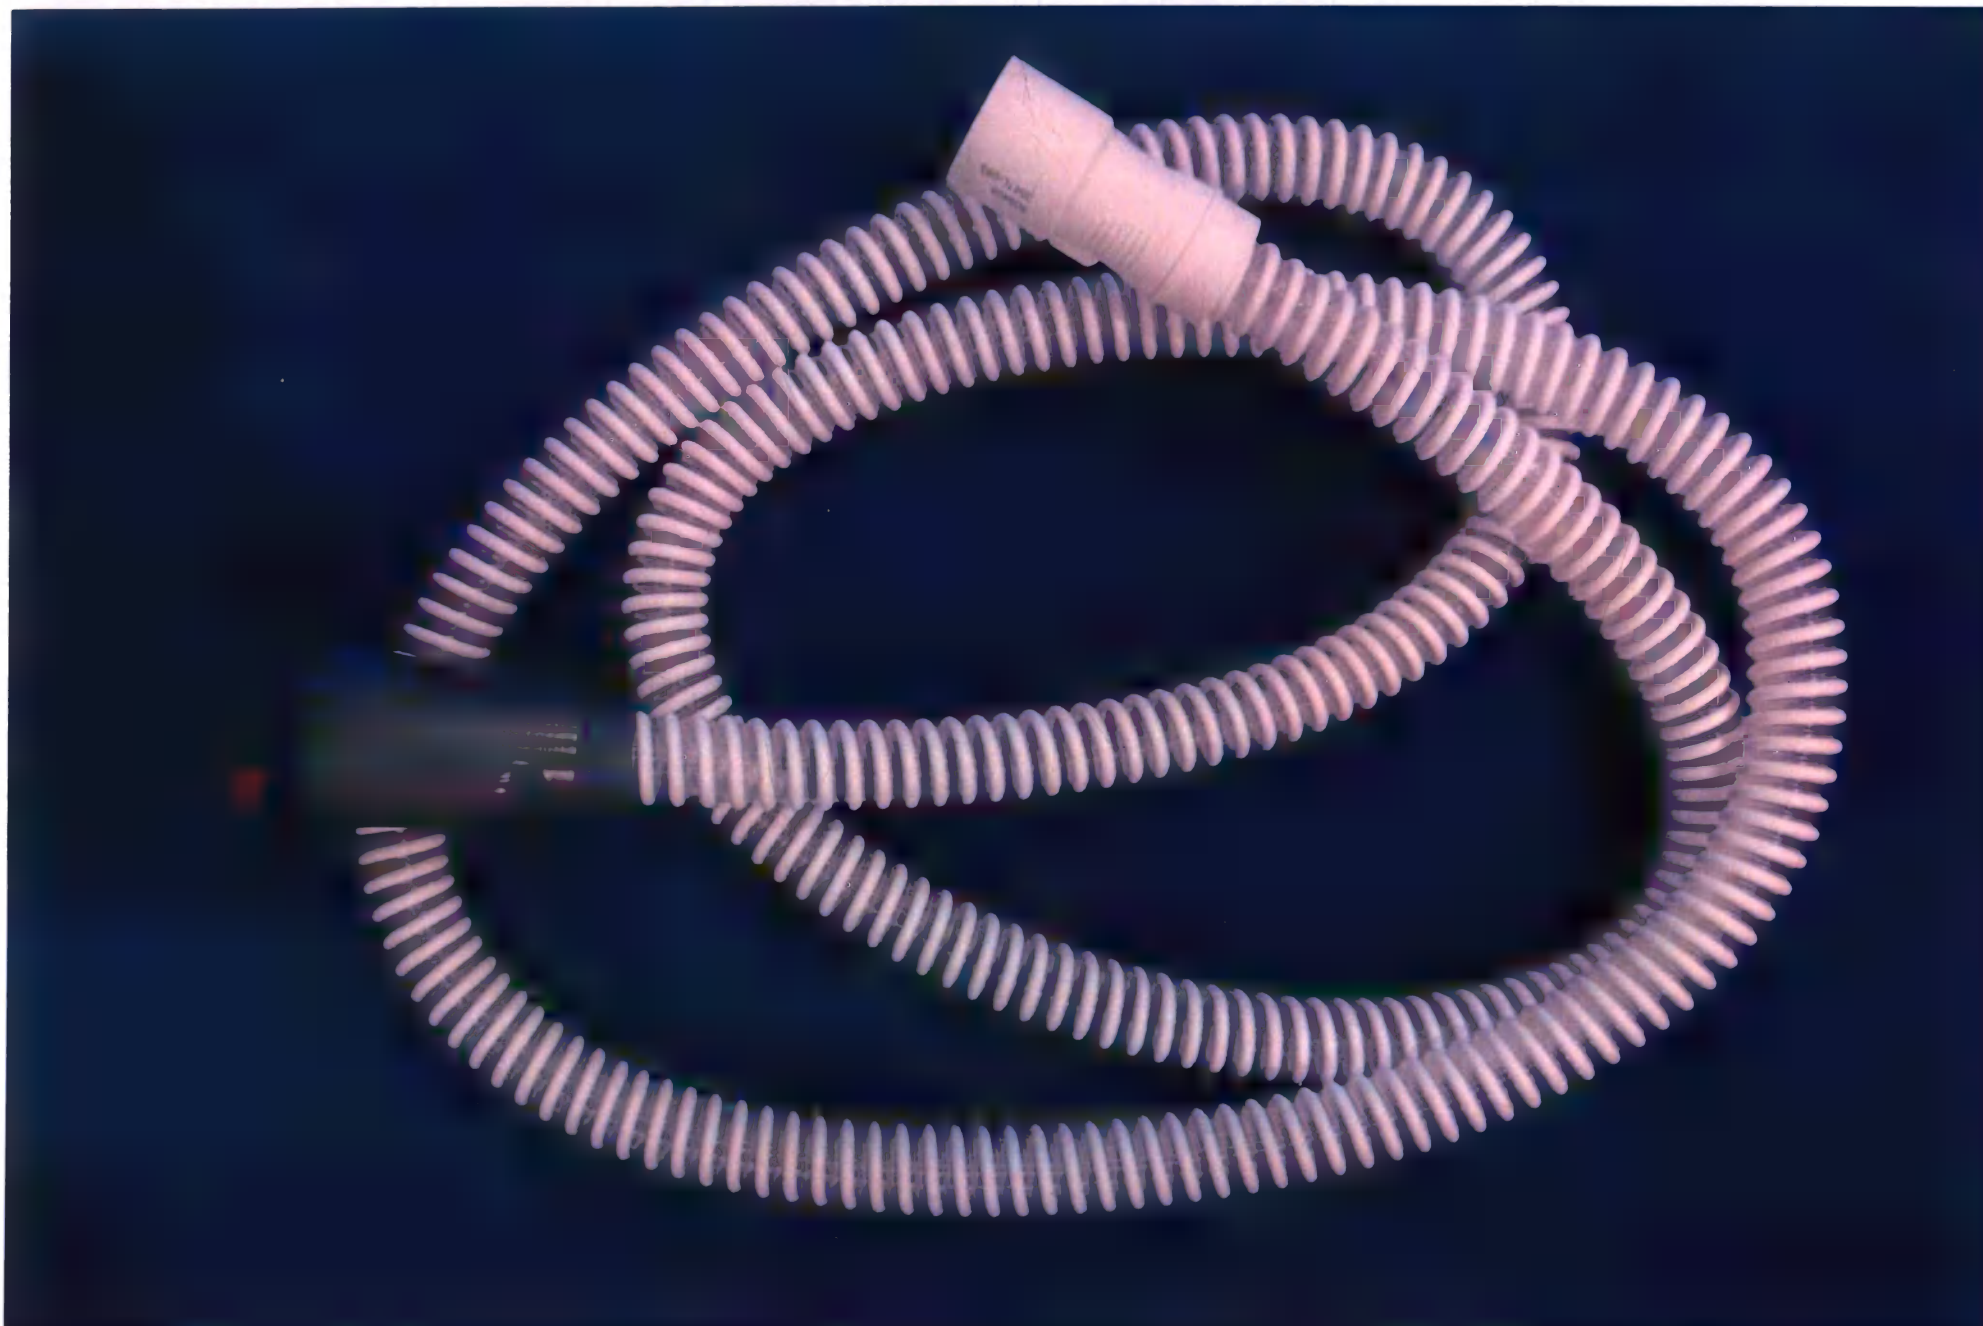

13. Контур пациента односоставной диаметром 22 мм, с фильтром антибактериальным низкого сопротивления, индивидуальный.

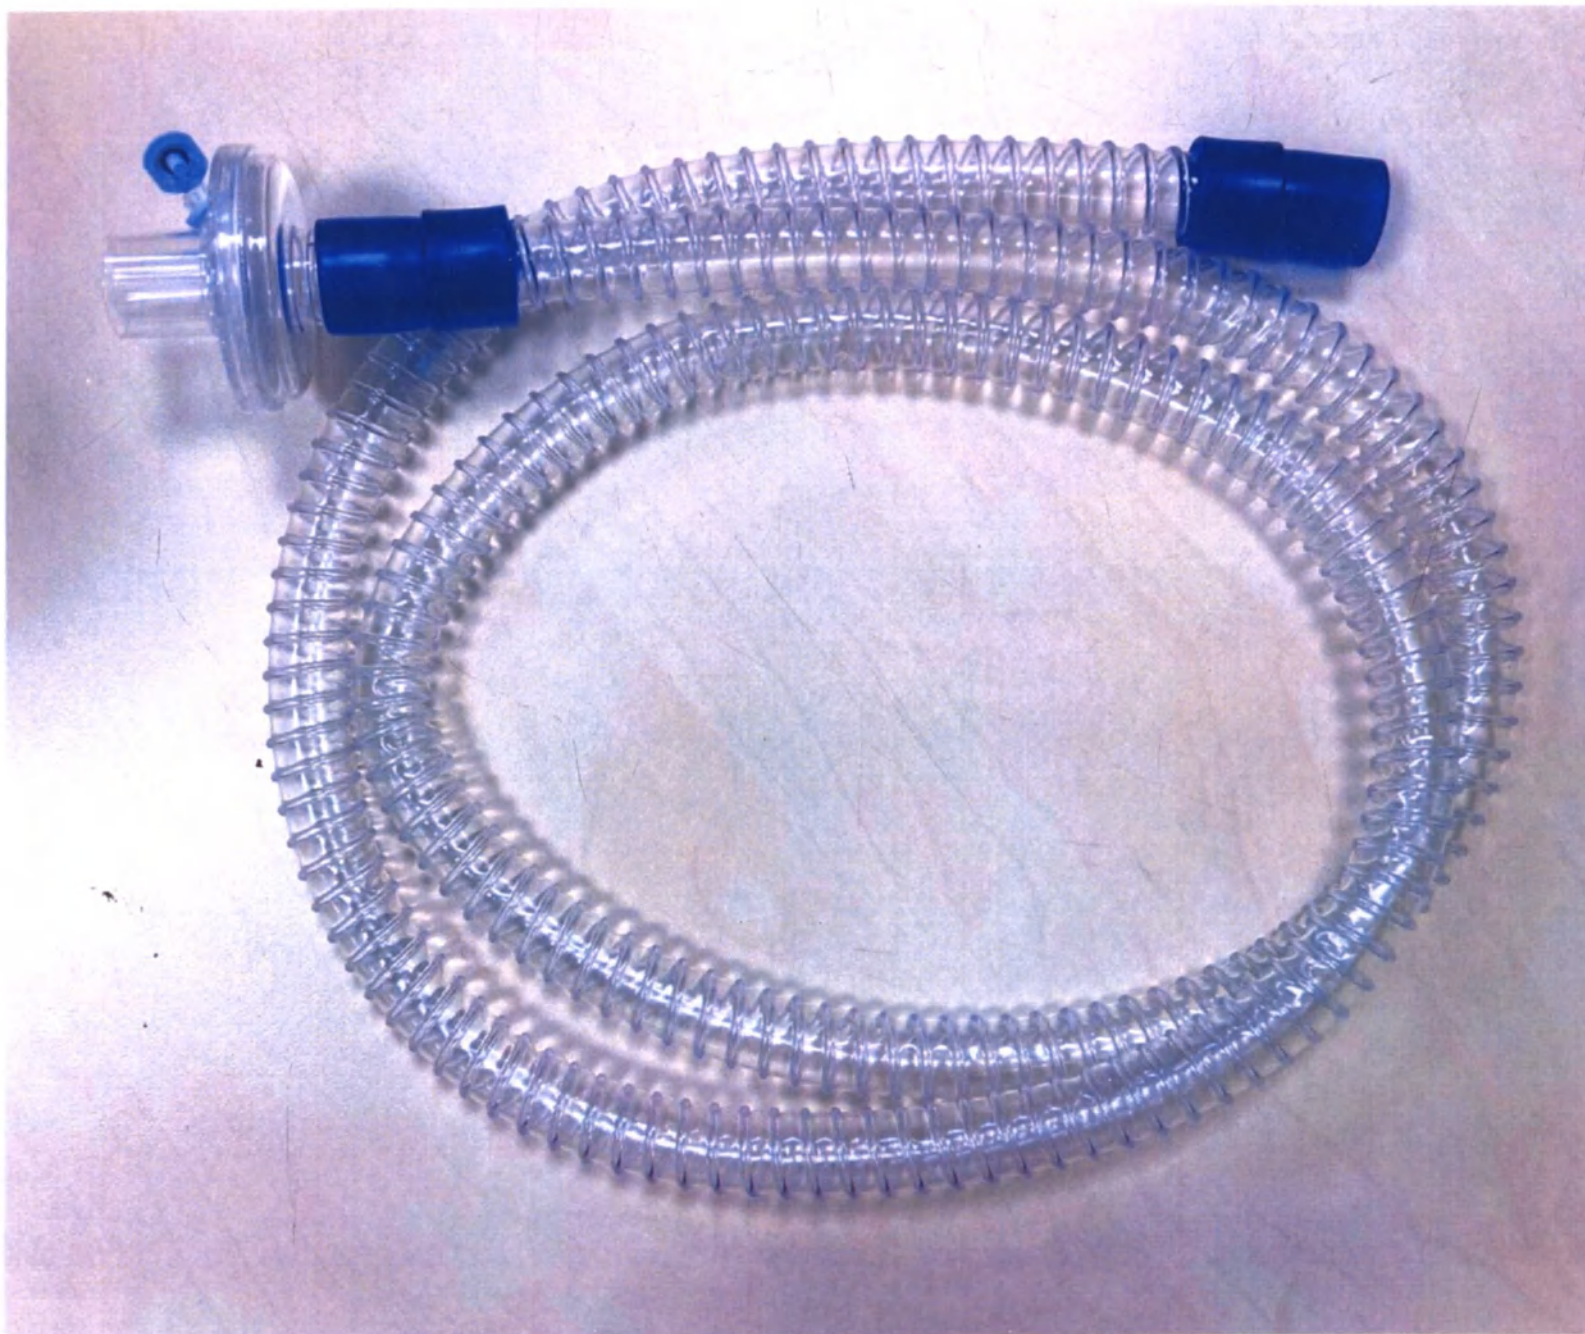

14. Порт утечки.

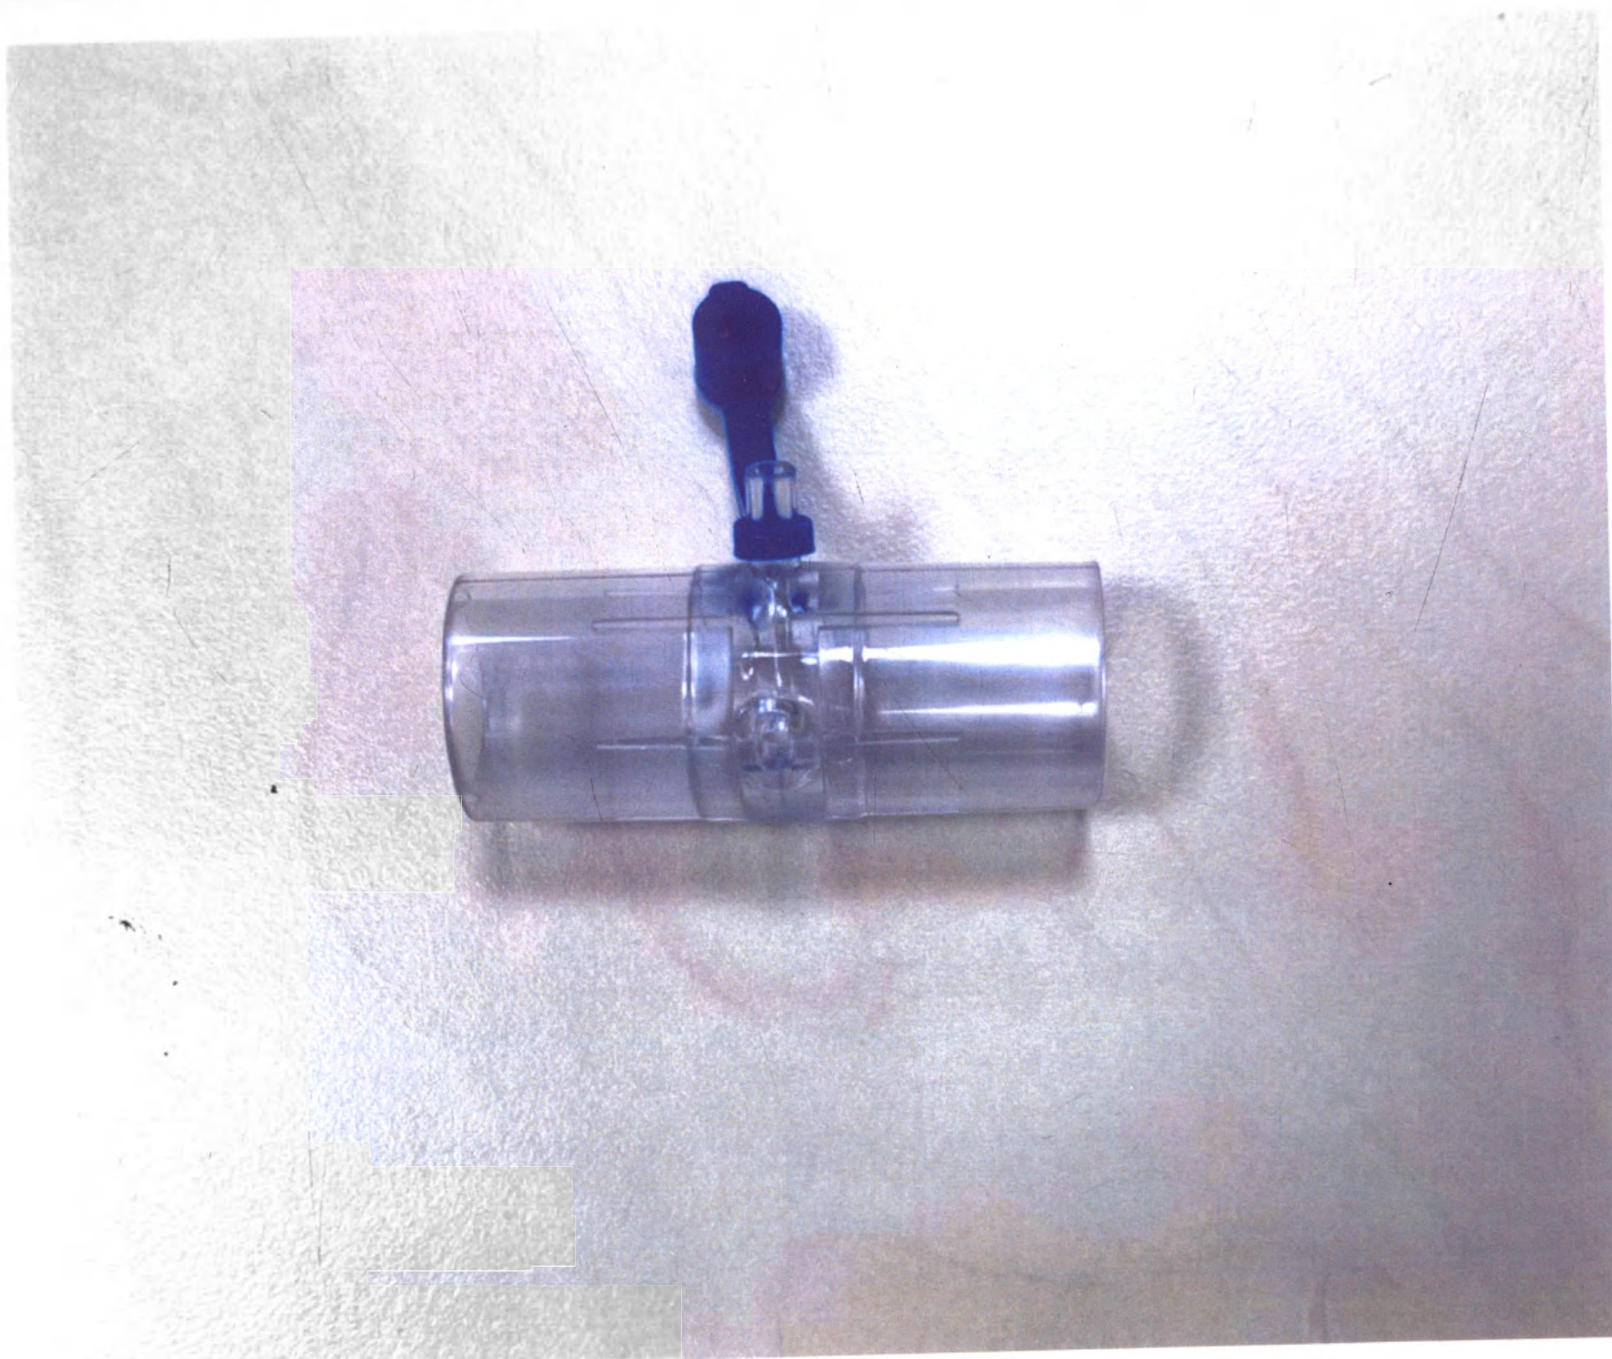




16. Фильтр антибактериальный низкого сопротивления.







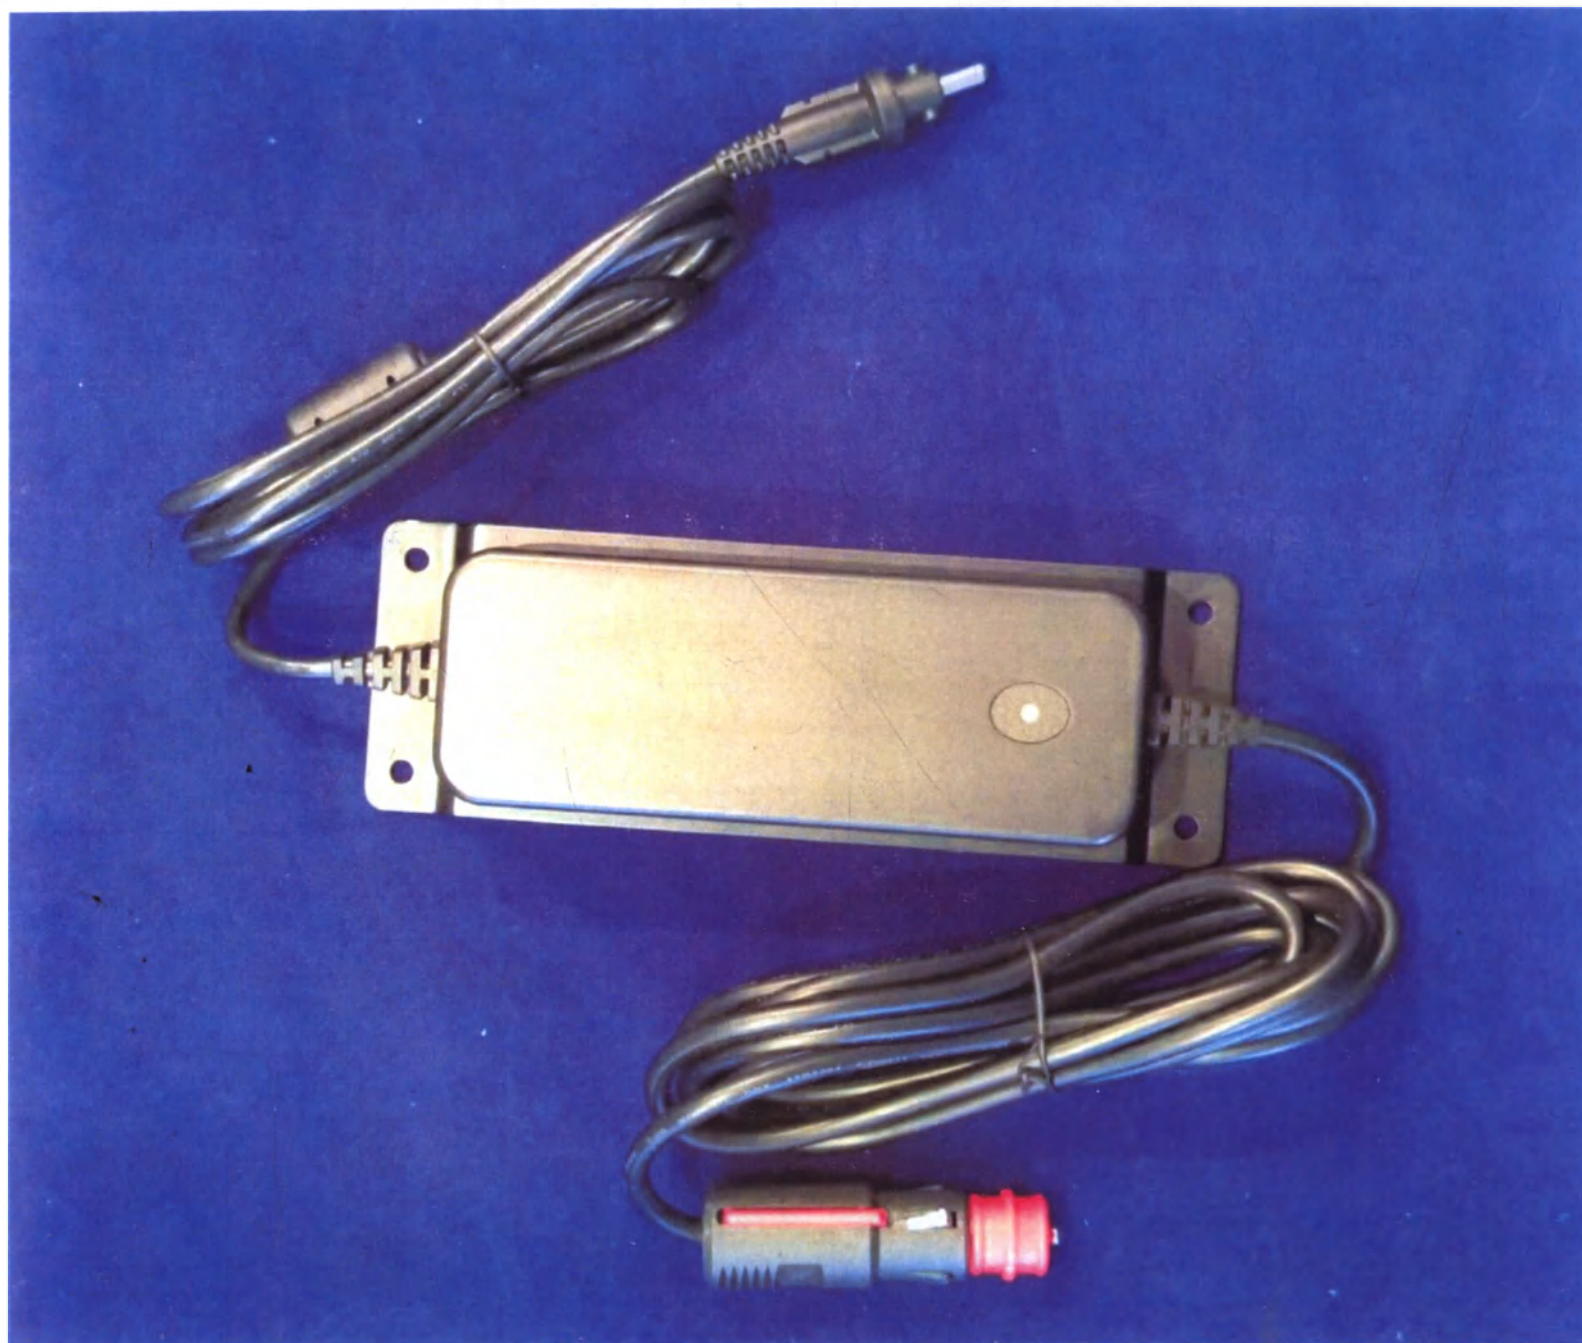

19. Y-кабель для одновременного подключения аппарата к электропитанию переменного и постоянного токов.



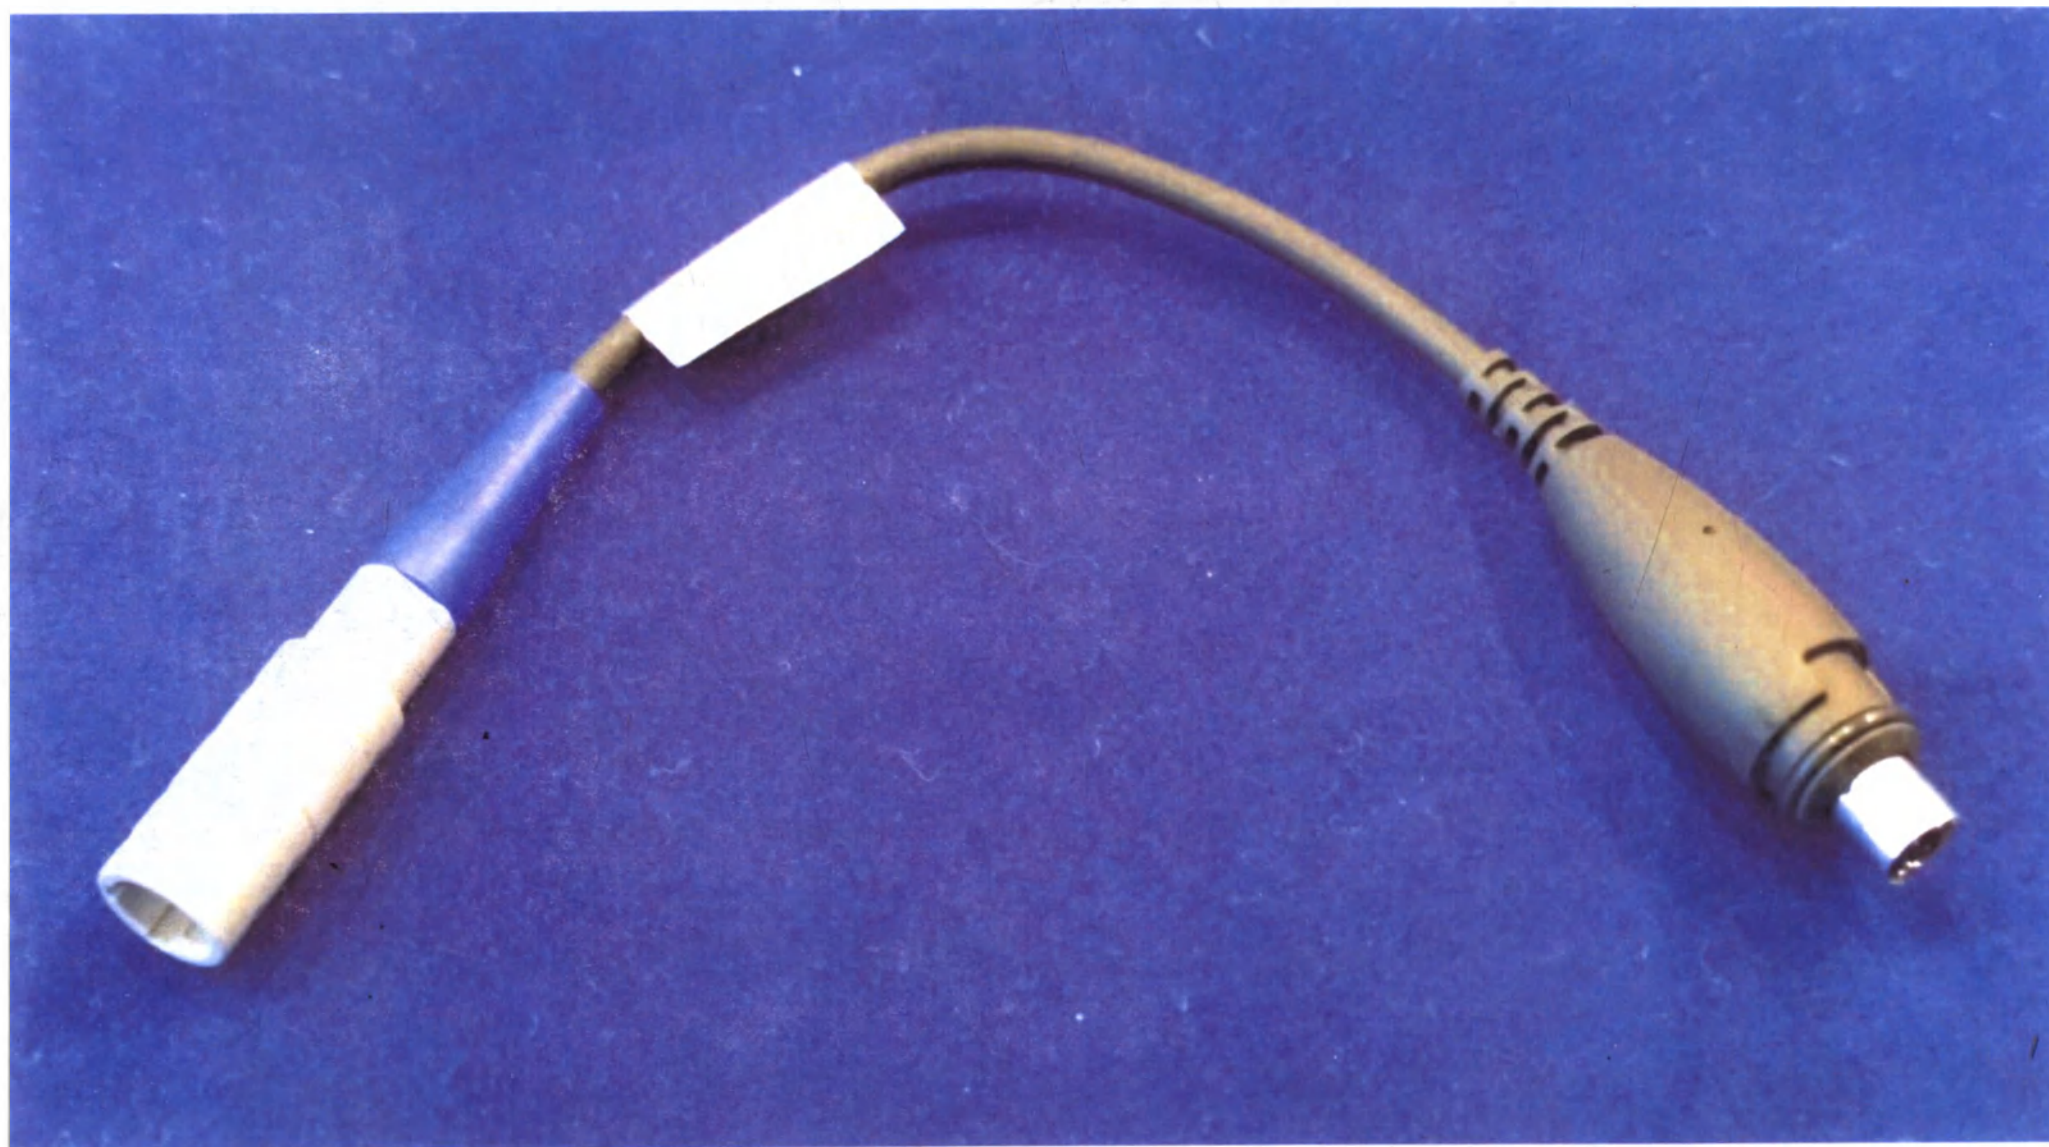

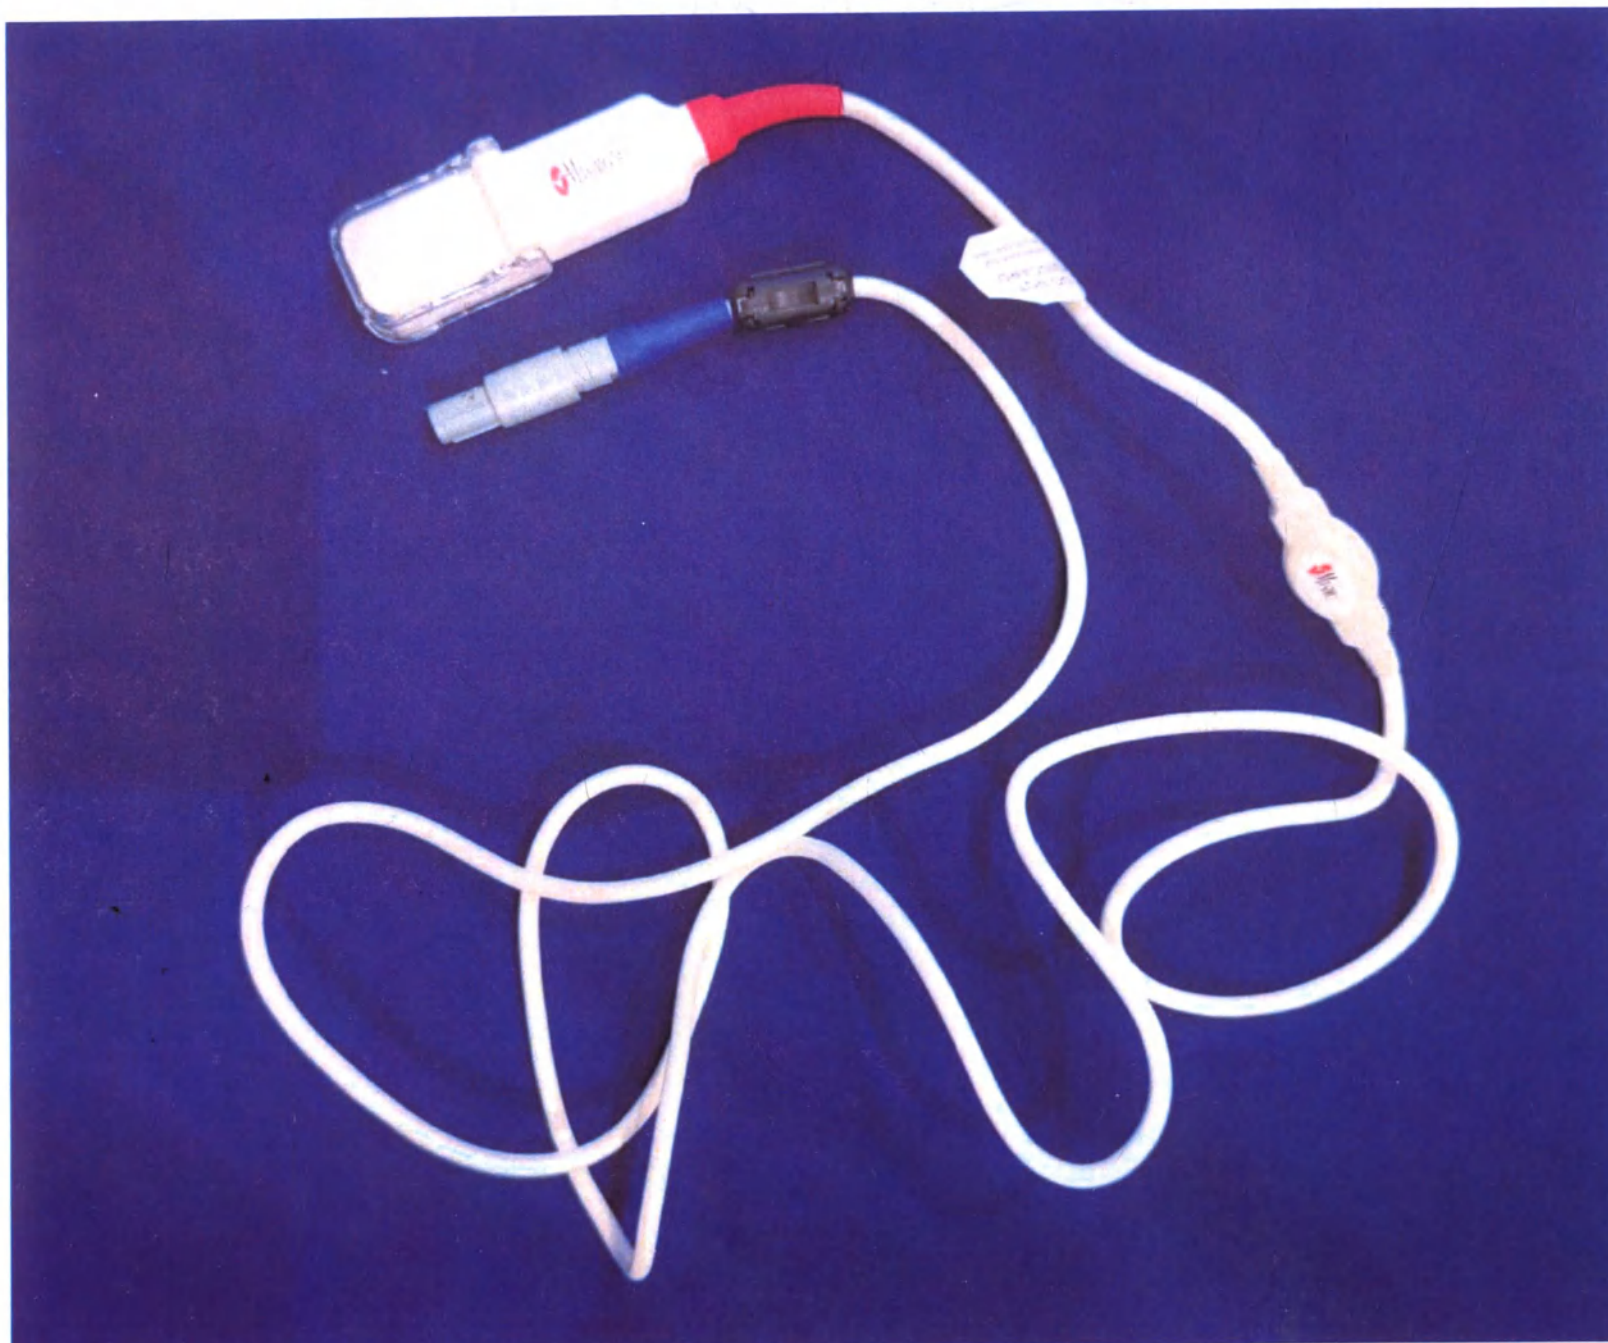

22. Датчик синхронизации по периферическому пульсу, тип клипса, для взрослых.




23. Датчик синхронизации по периферическому пульсу, тип клипса, для детей.



24. Батарея аккумуляторная внешняя, двойная.




25. Кабель соединительный для батареи аккумуляторной внешней.

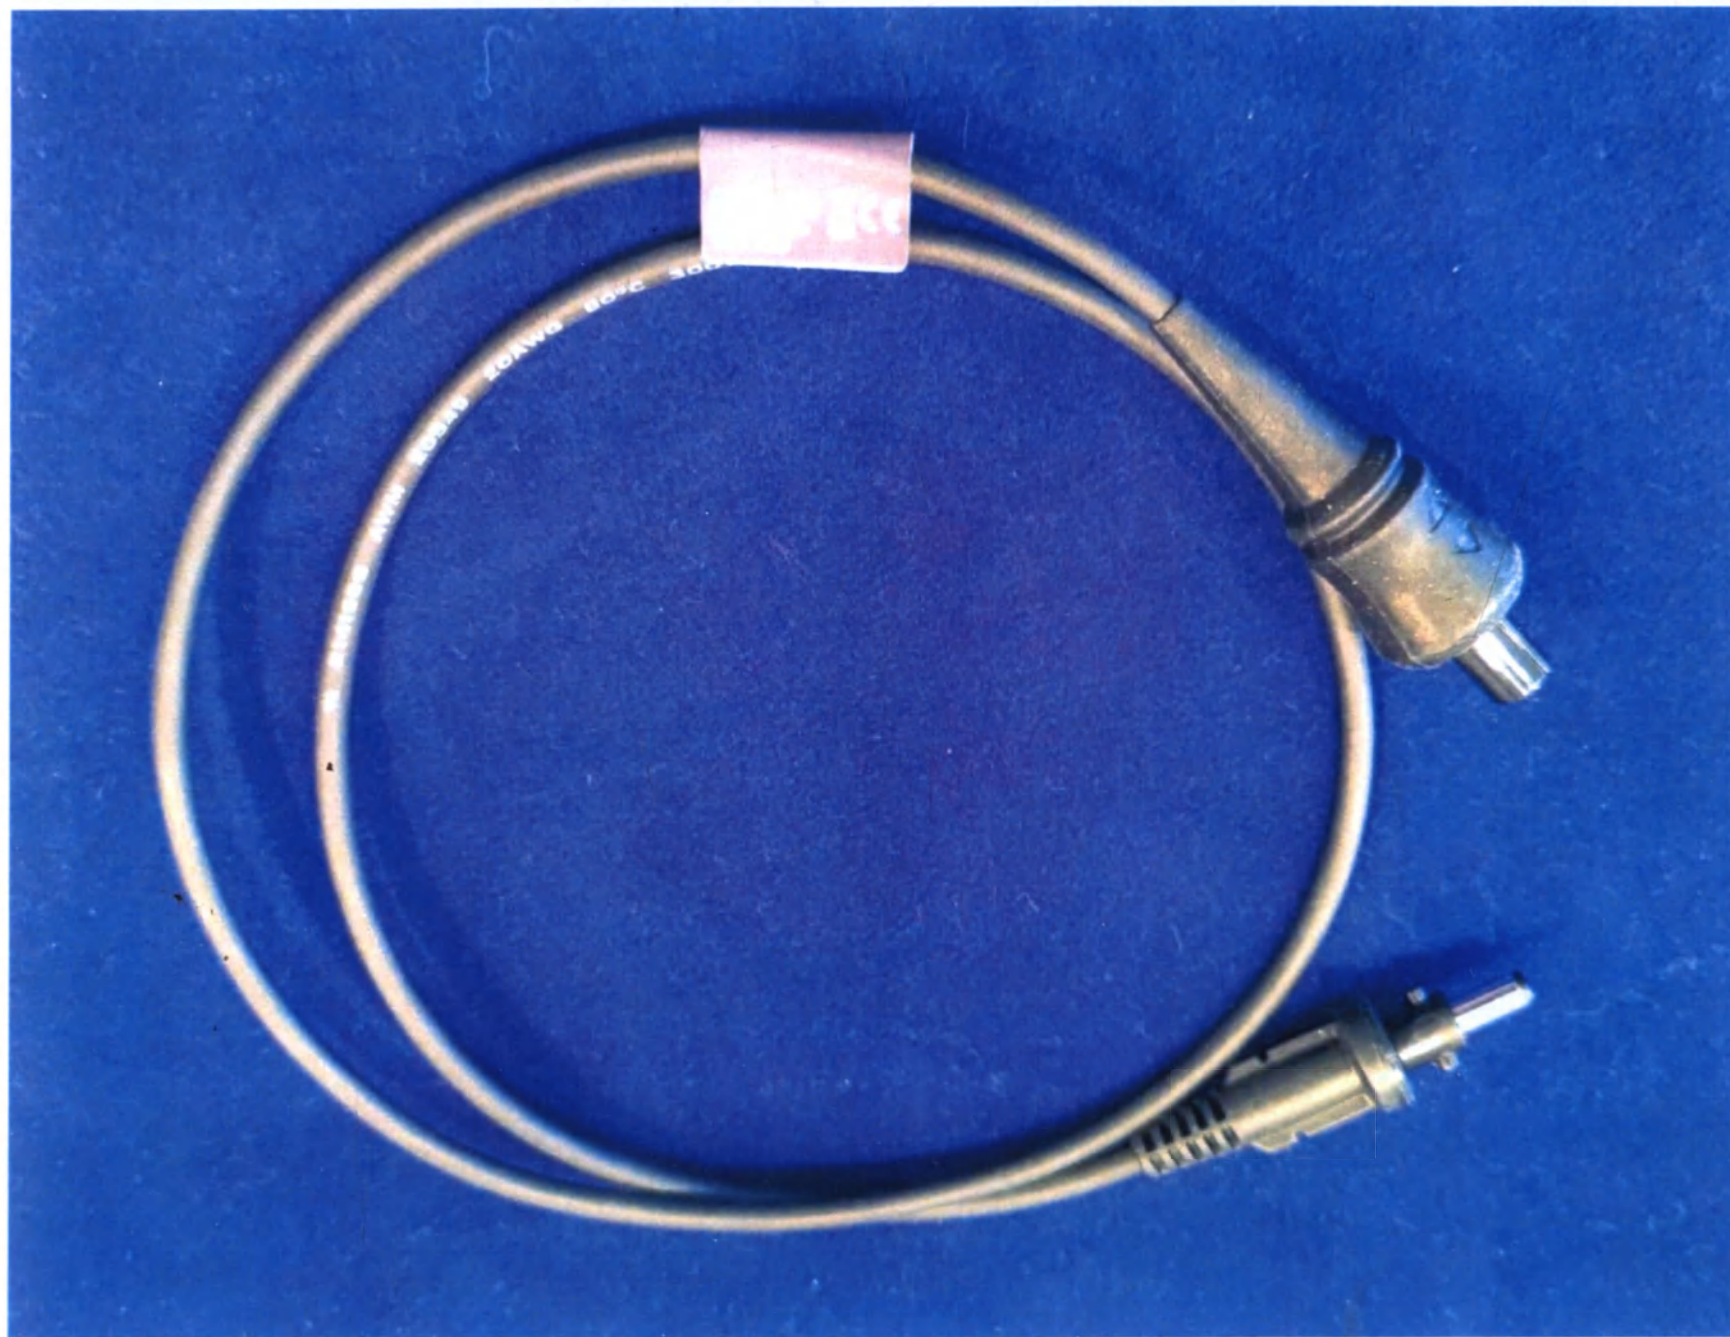







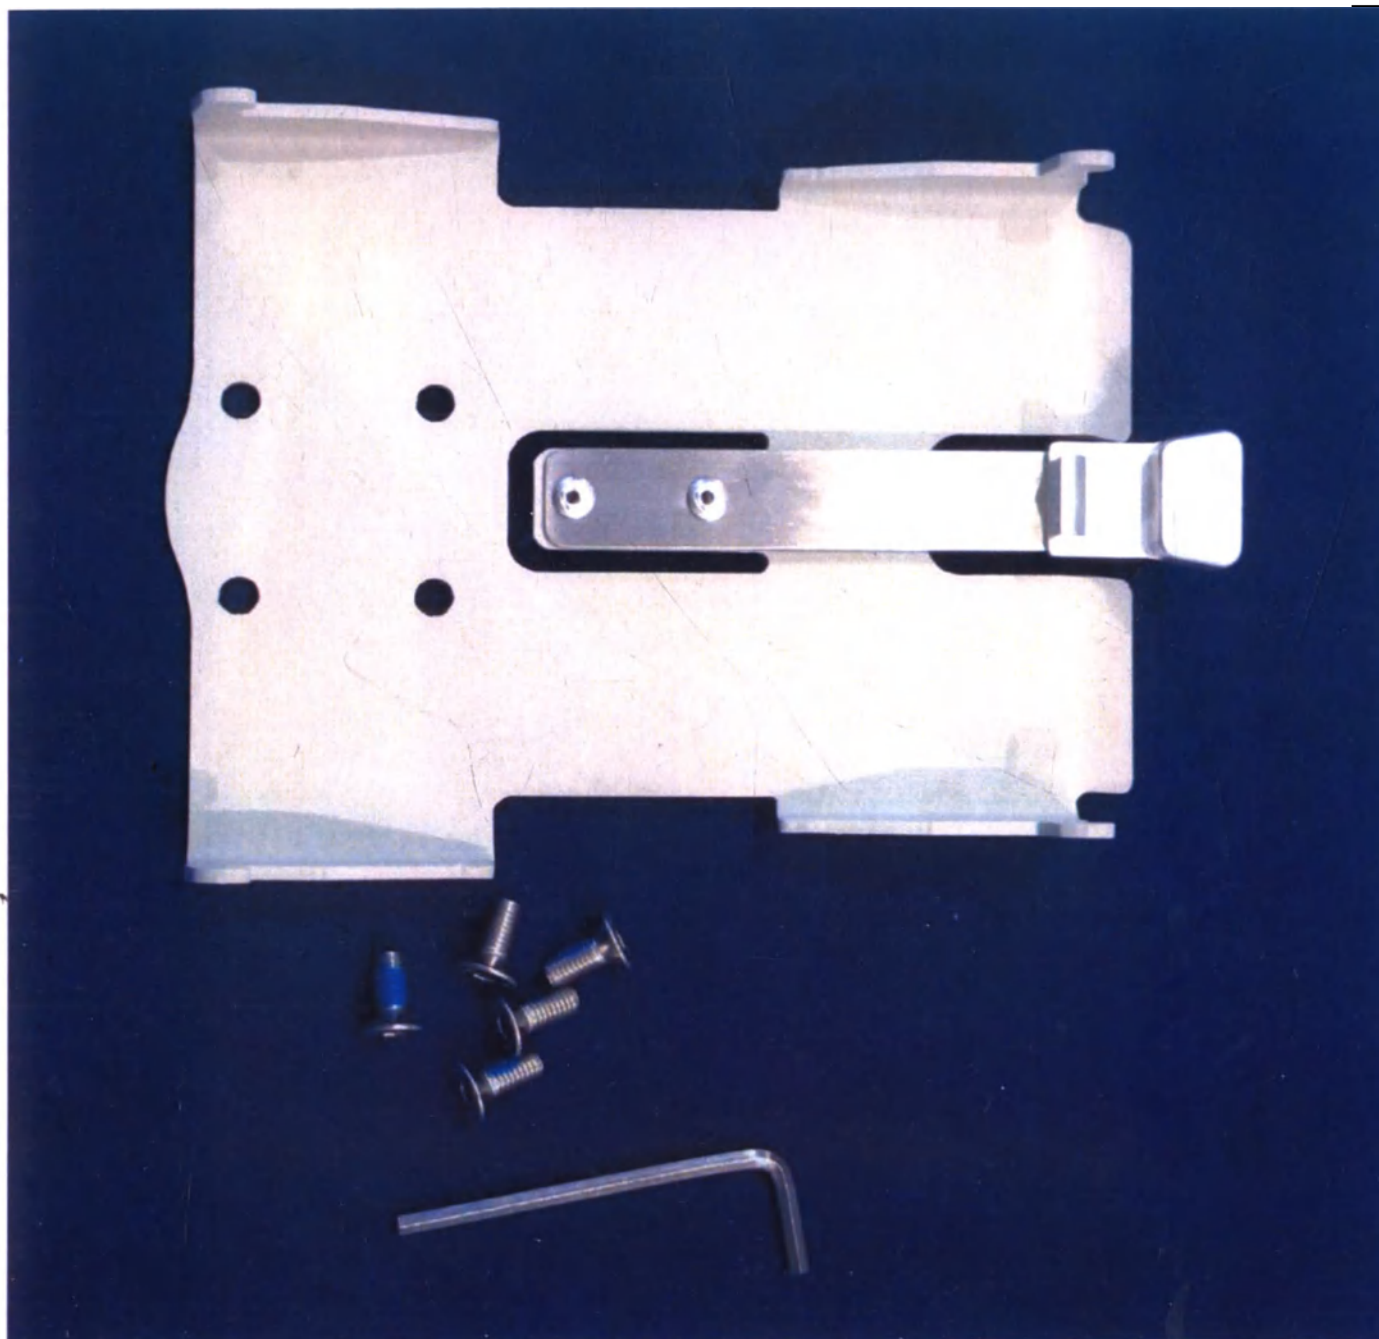



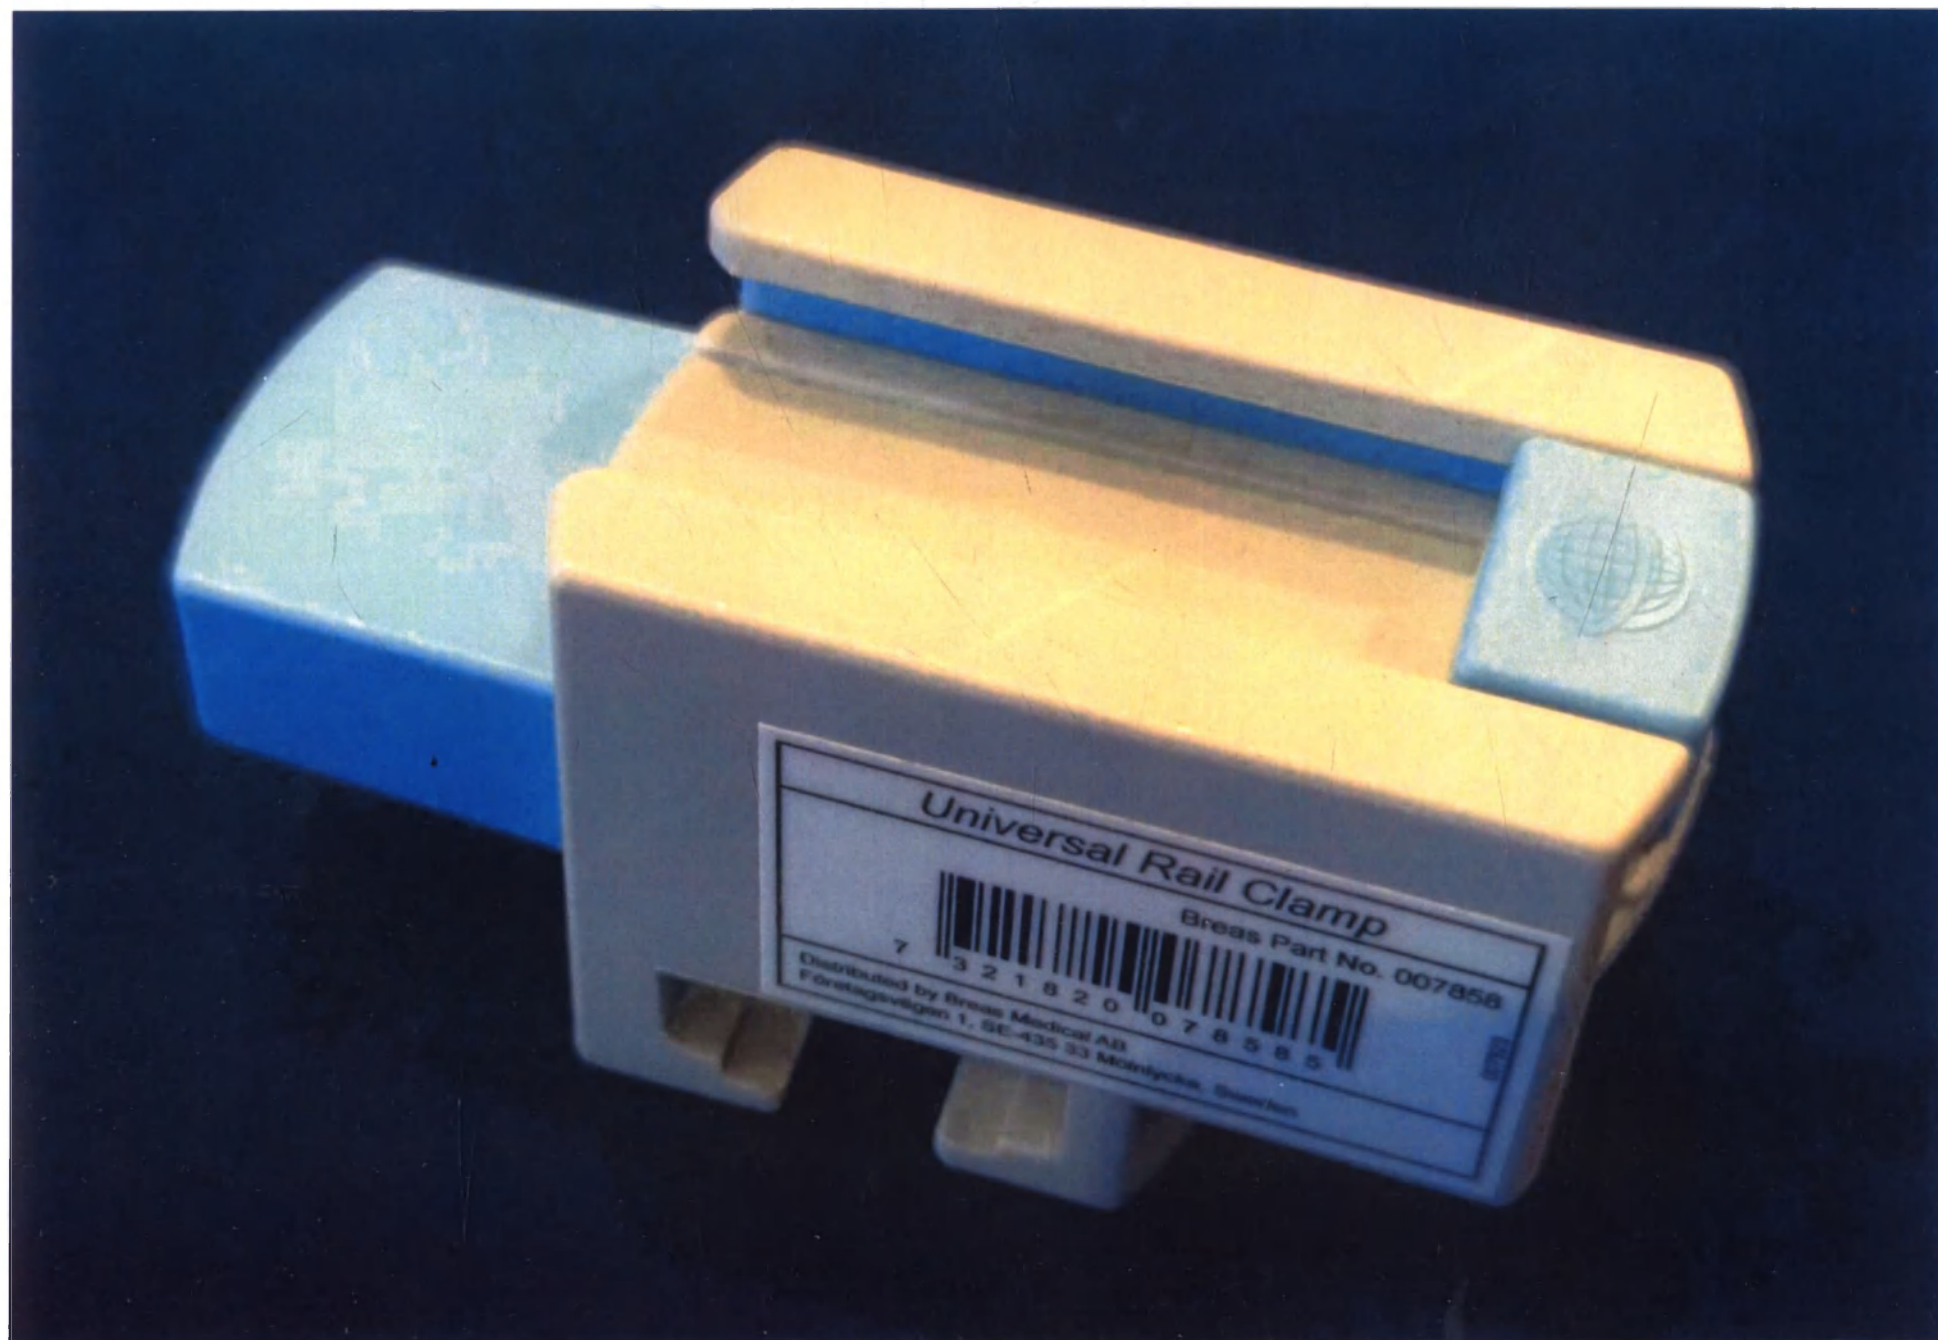


31. Держатель универсальный.

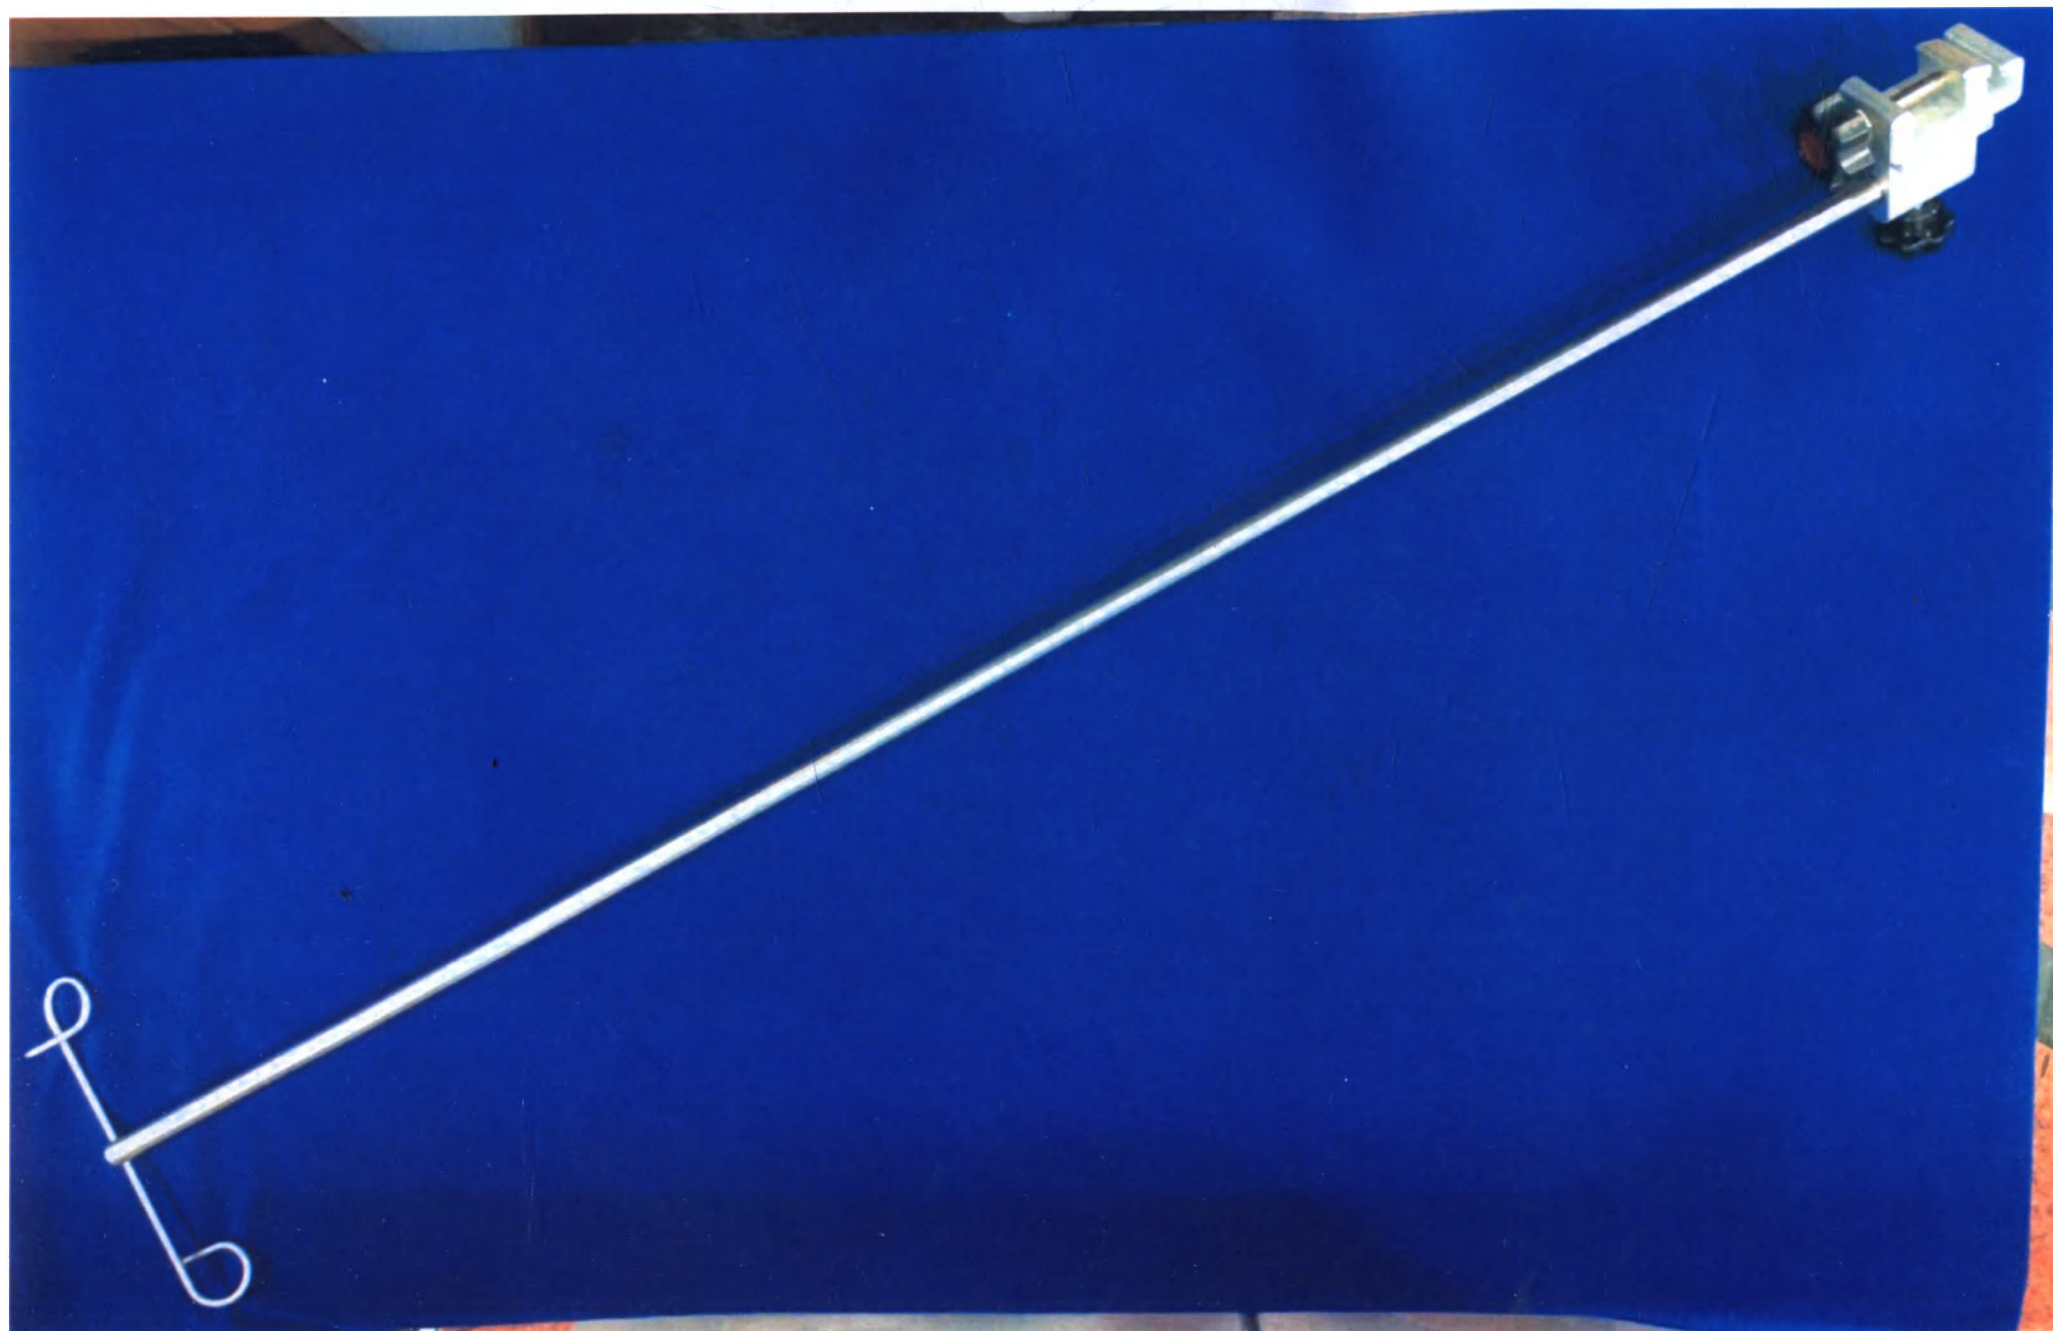

32. Колба увлажнителя.



33. Картридж нагревательный для увлажнителя.

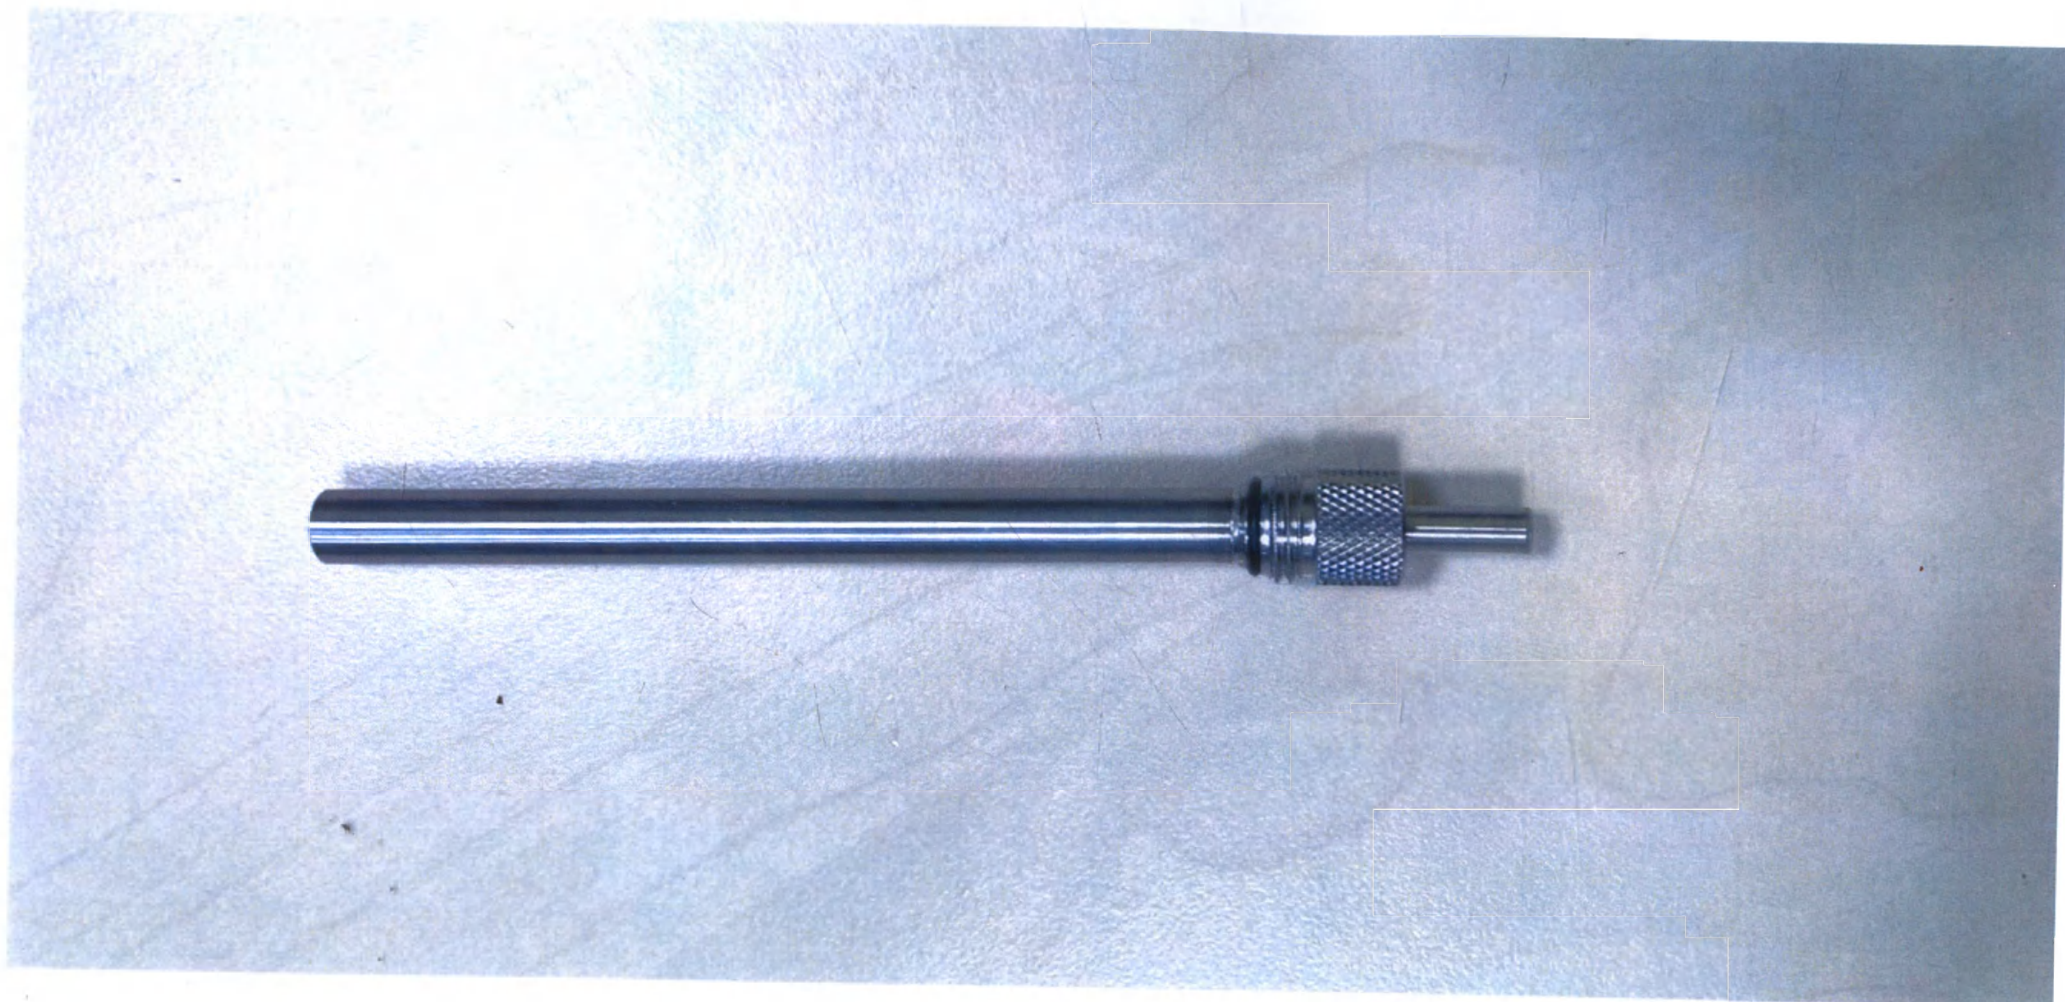

34. Сумка транспортная батареи аккумуляторной внешней.





36. Лёгкая транспортная сумка.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VIVO
by Breco



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
38 (тридцать восемь) листов



Генеральный директор
ООО «С-Инструментс Медикал»

Д.В.Соколов

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «С-Инструментс Медикал»
Д.В. Соколов



(подпись)
«21» июня 2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия


Аппарат искусственной вентиляции легких серии Vivo, вариант исполнения Vivo 2.



2. Крышка обходная, воздушная.




3. Держатель фильтров.

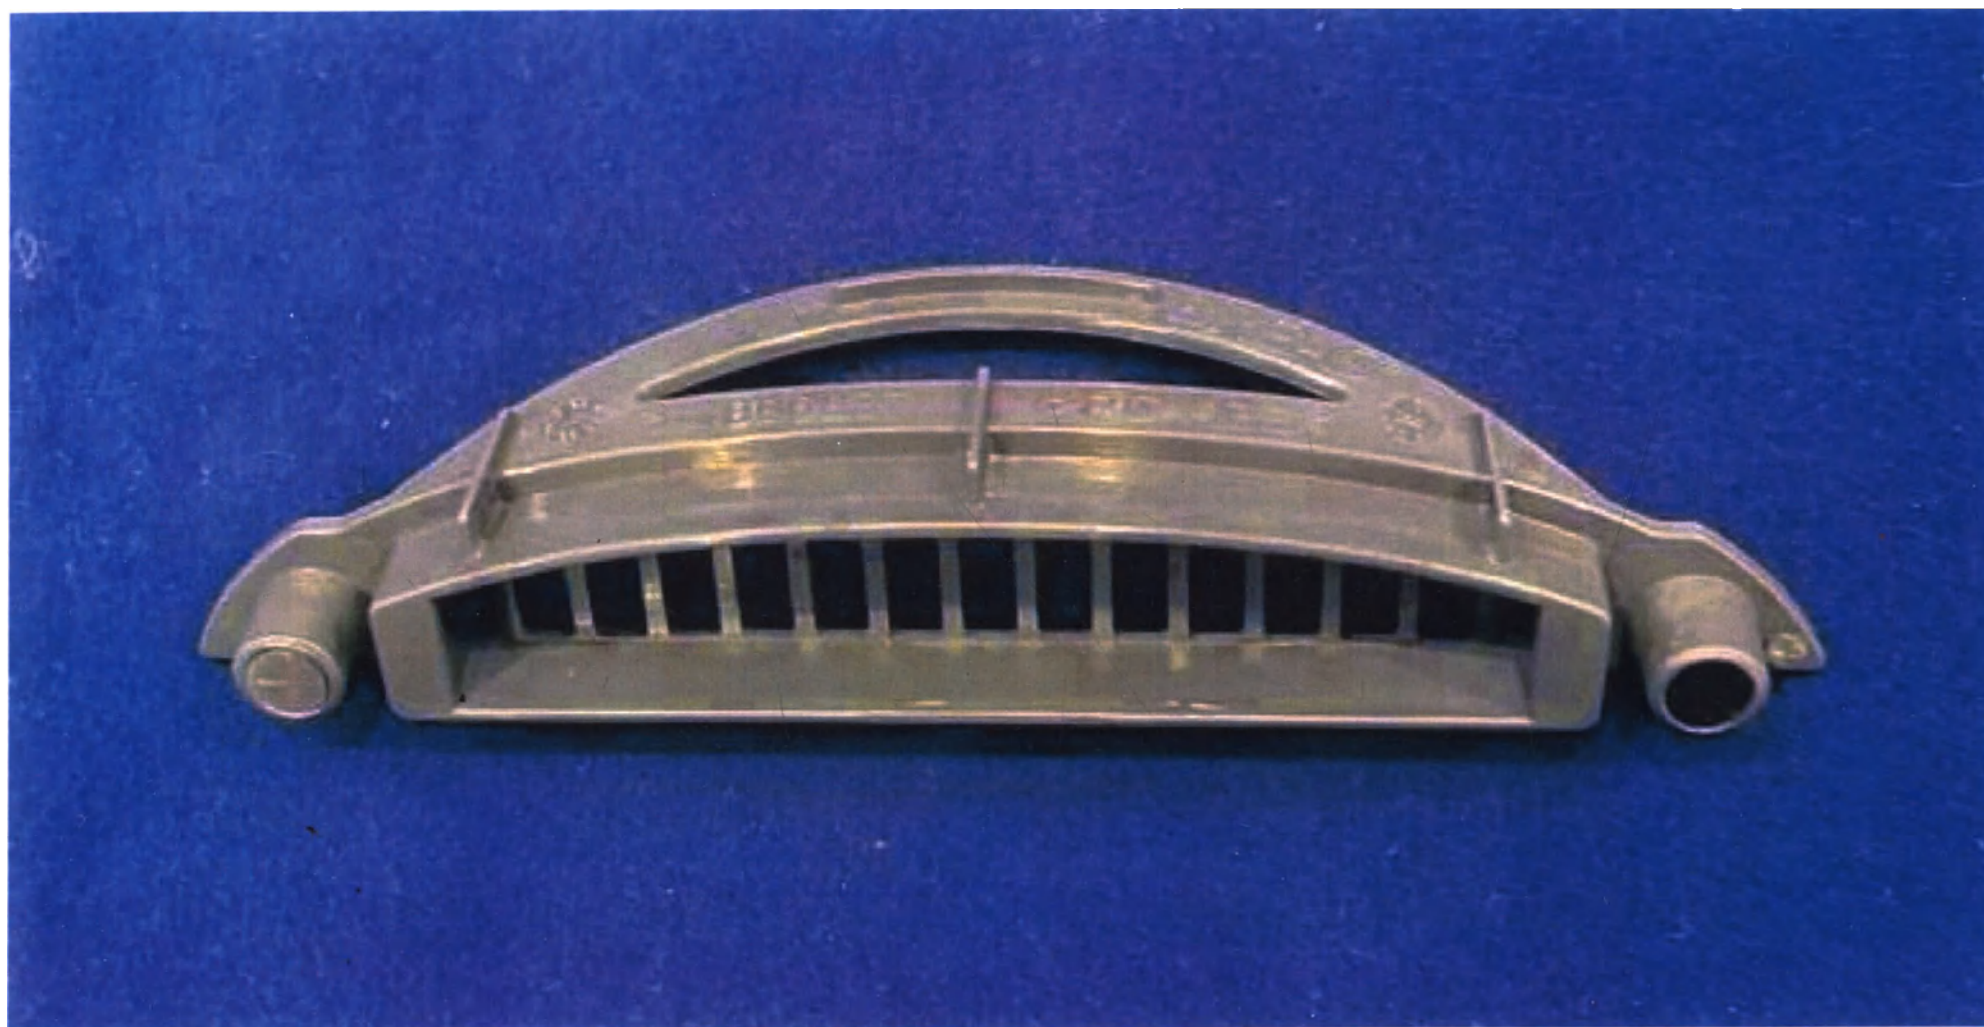


4. Фильтр воздухозаборного отверстия, грубой очистки.




5. Фильтр воздухозаборного отверстия, тонкой очистки.

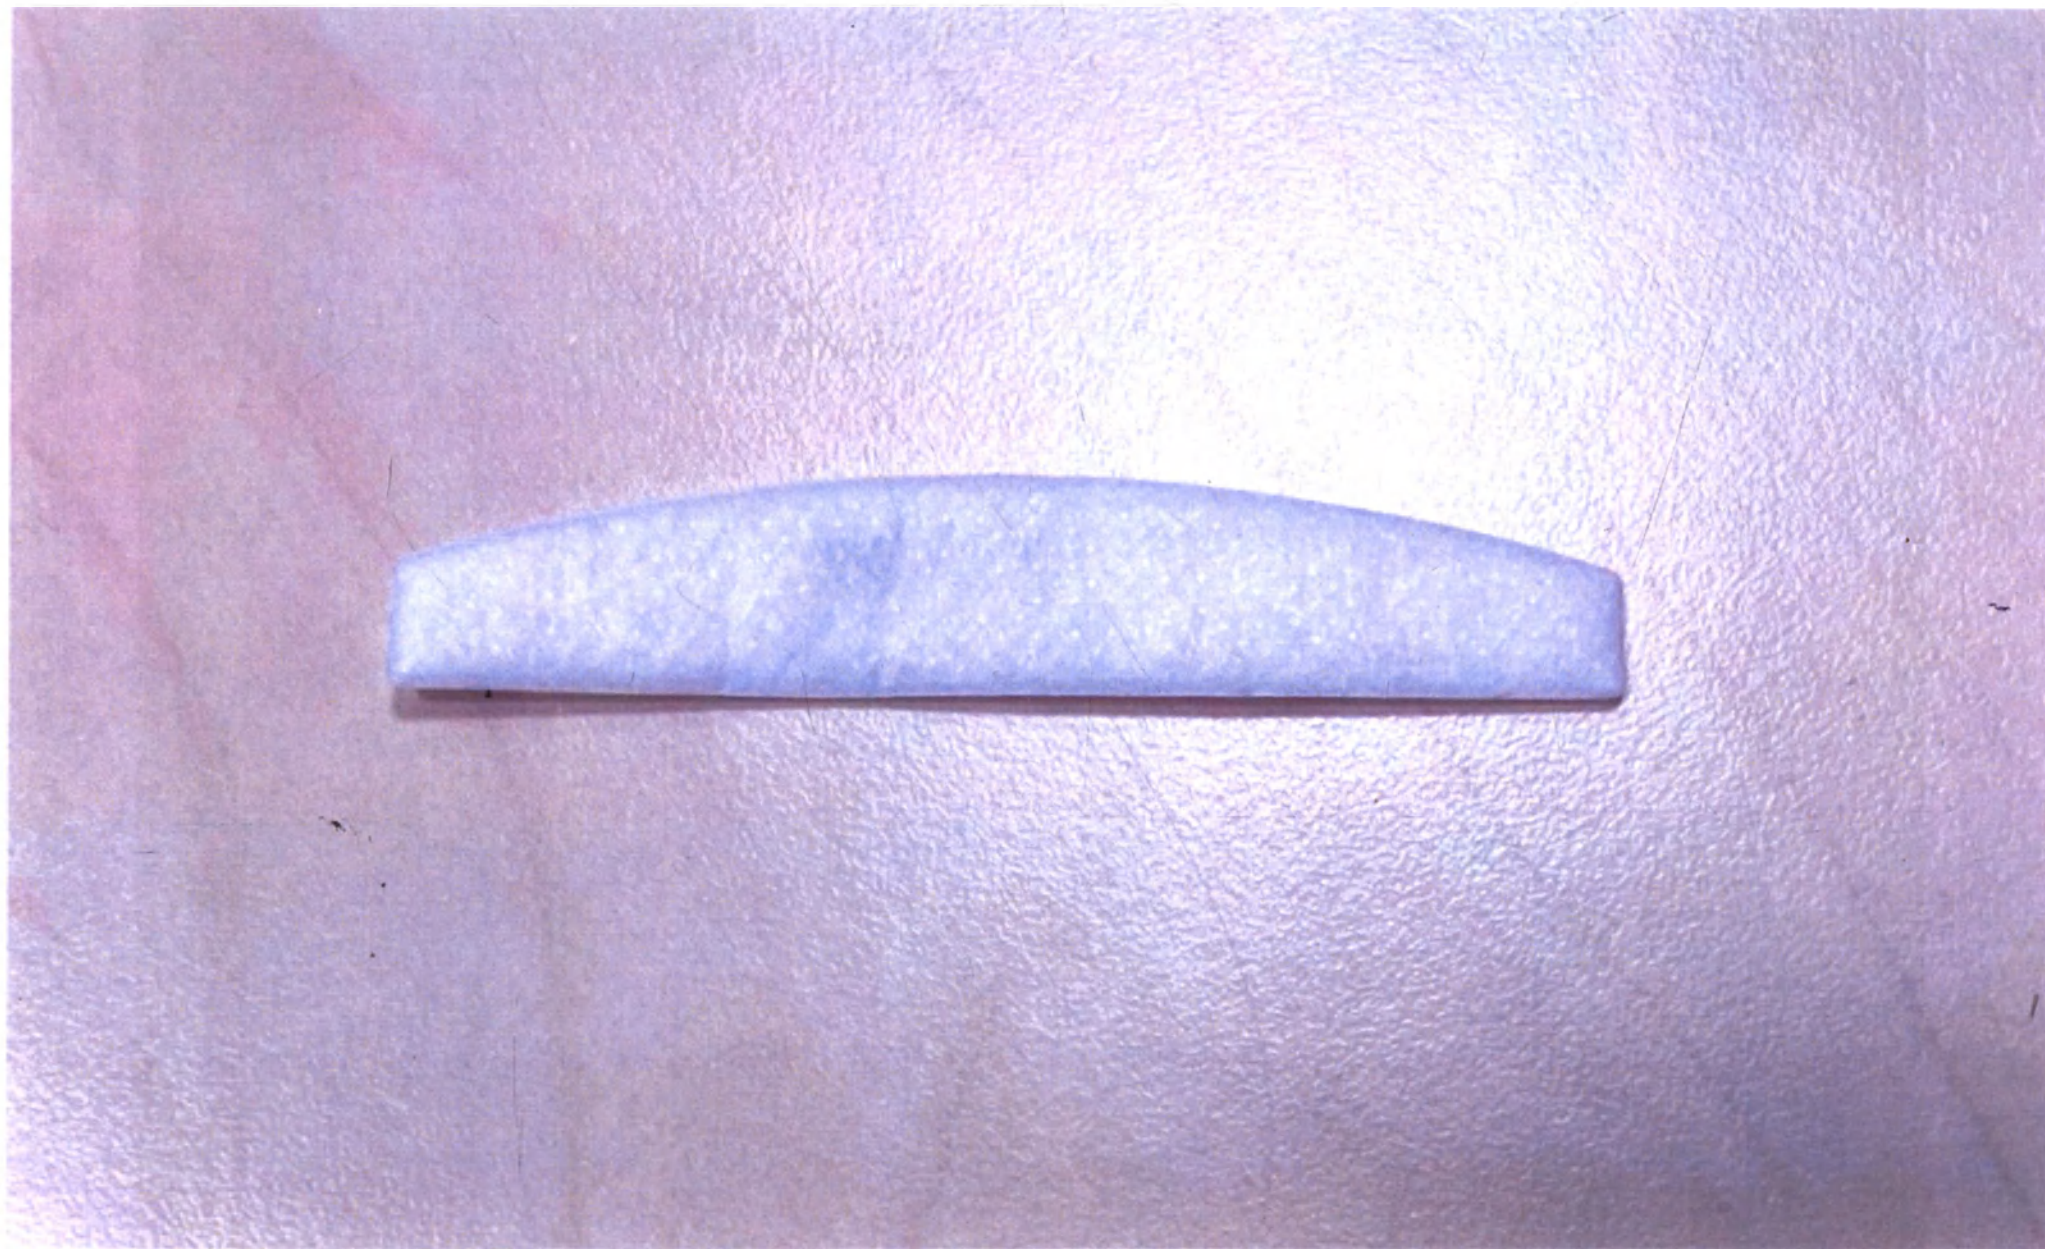


6. Адаптер питания AC/DC.

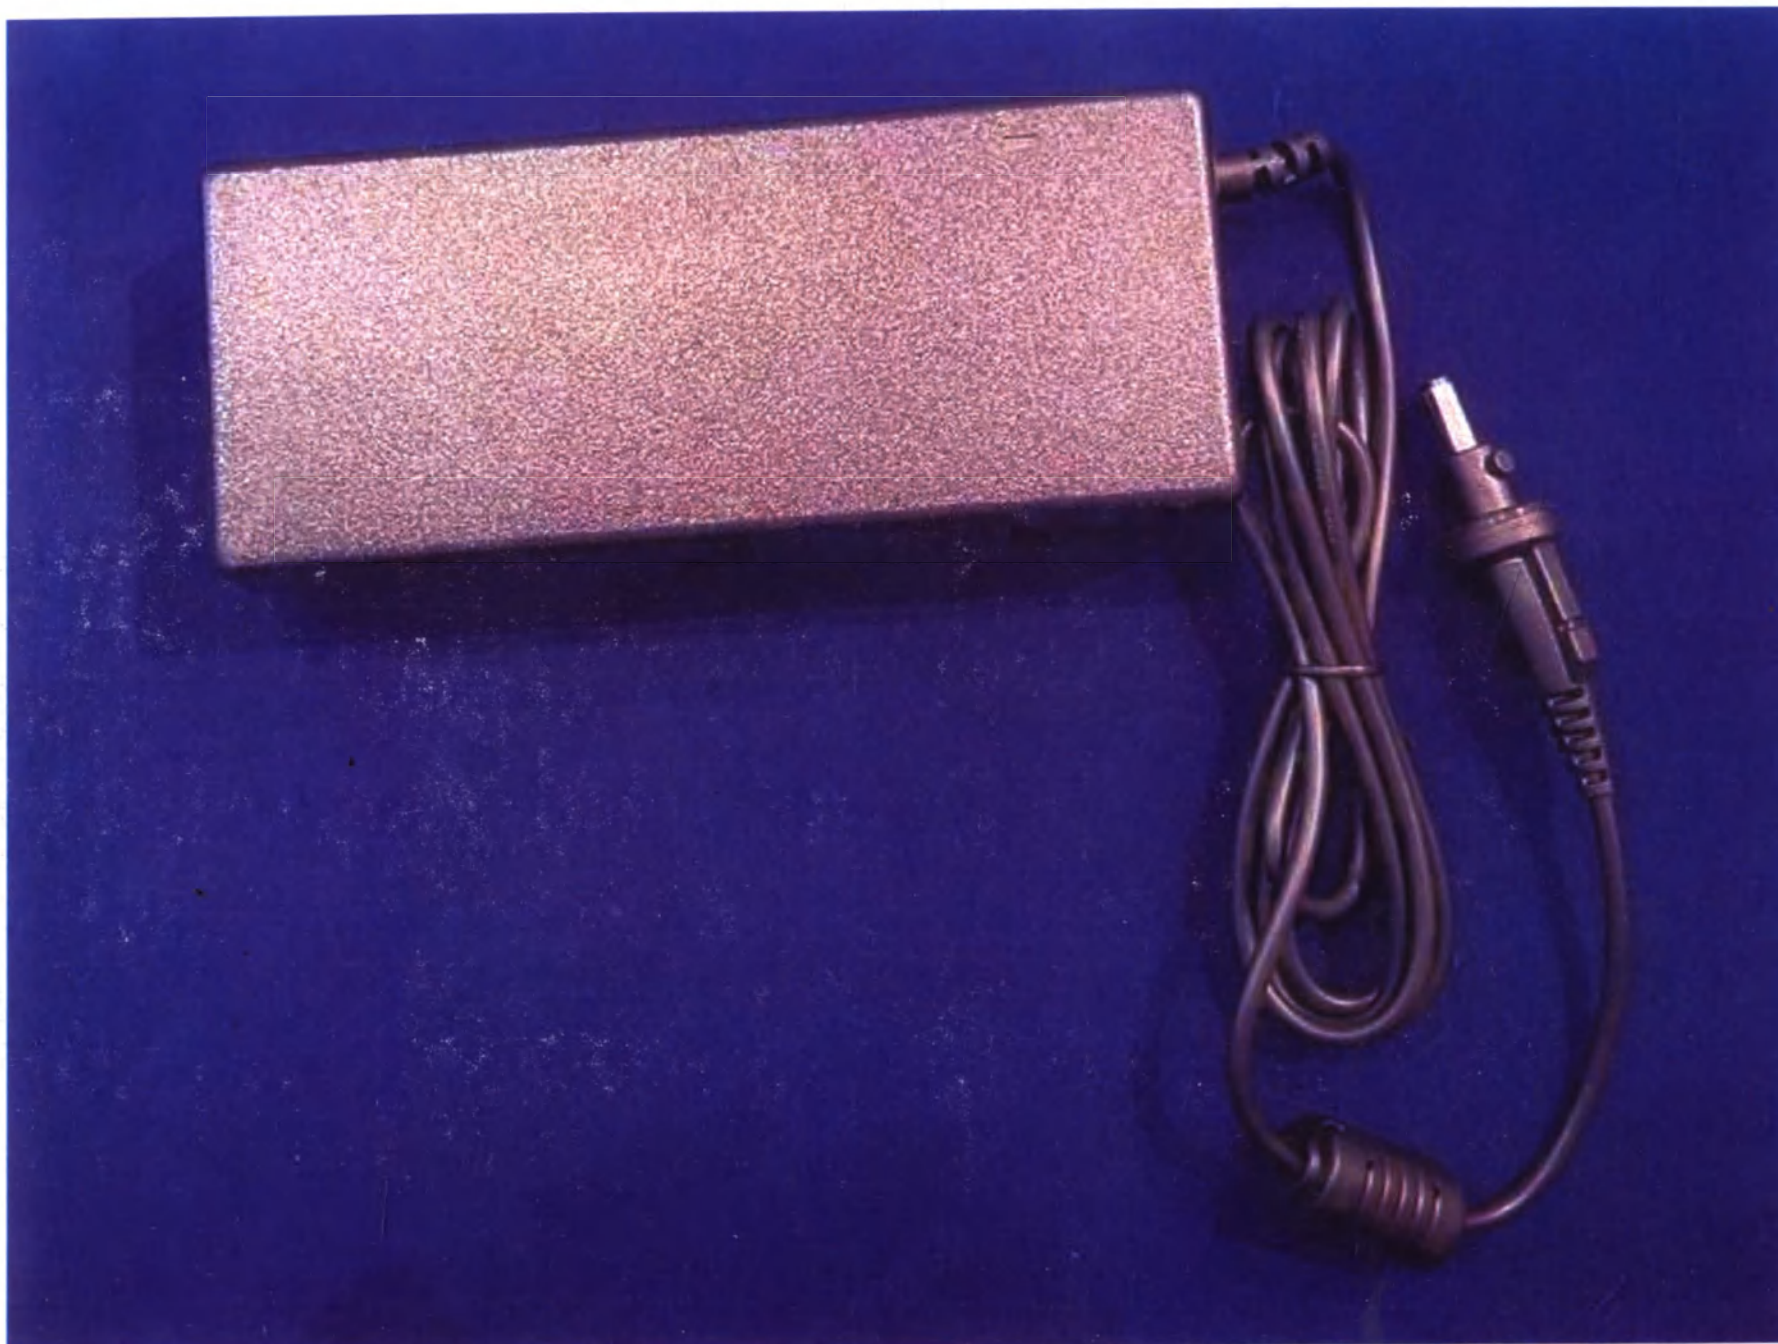

7. Кабель сетевой.

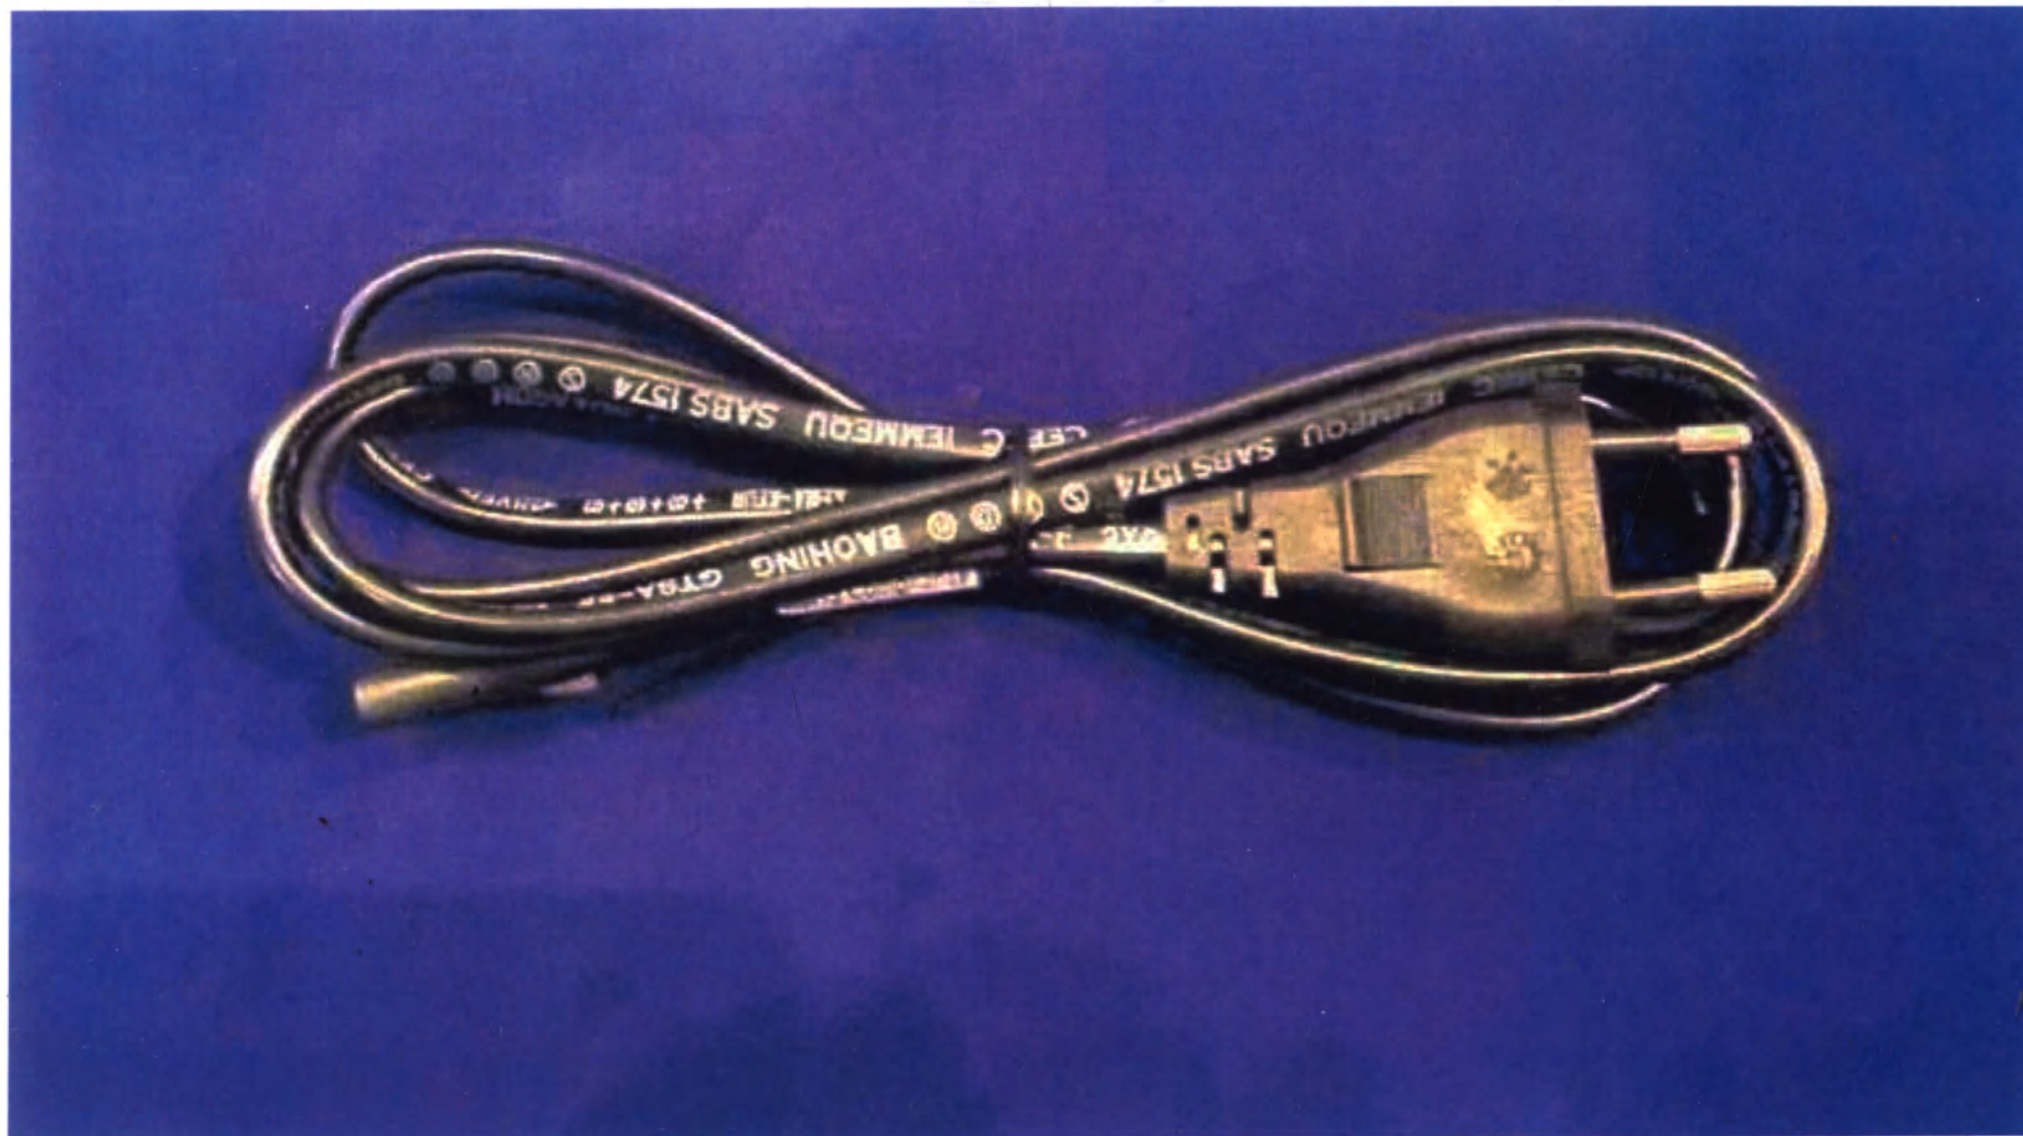

8. Штуцер кислорода низкого давления.

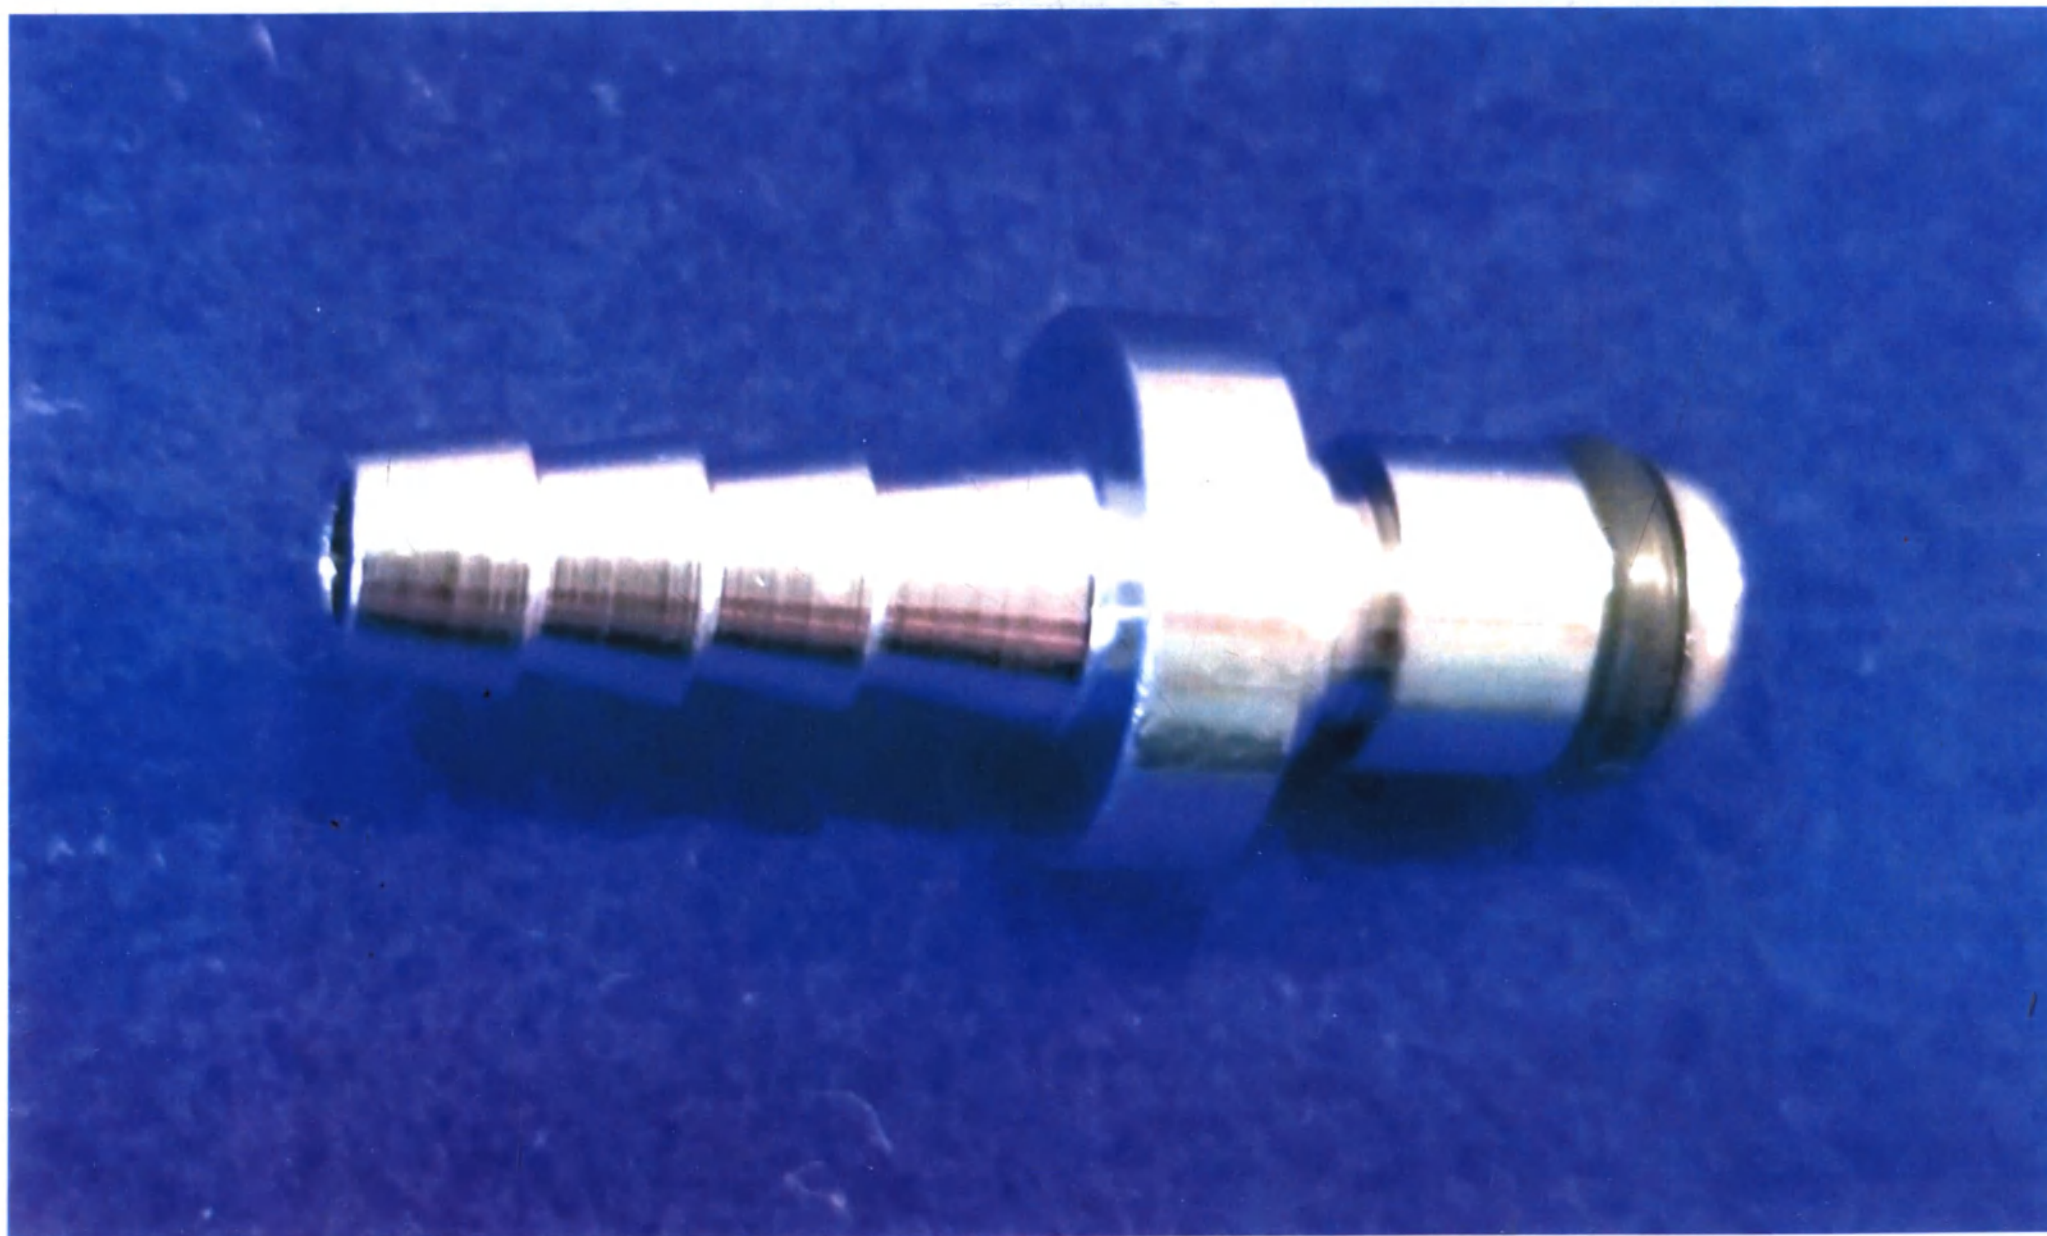


9. Сумка для транспортировки.




10. Контур пациента односоставной диаметром 15 мм, индивидуальный.




11. Контур пациента односоставной диаметром 22 мм, индивидуальный.

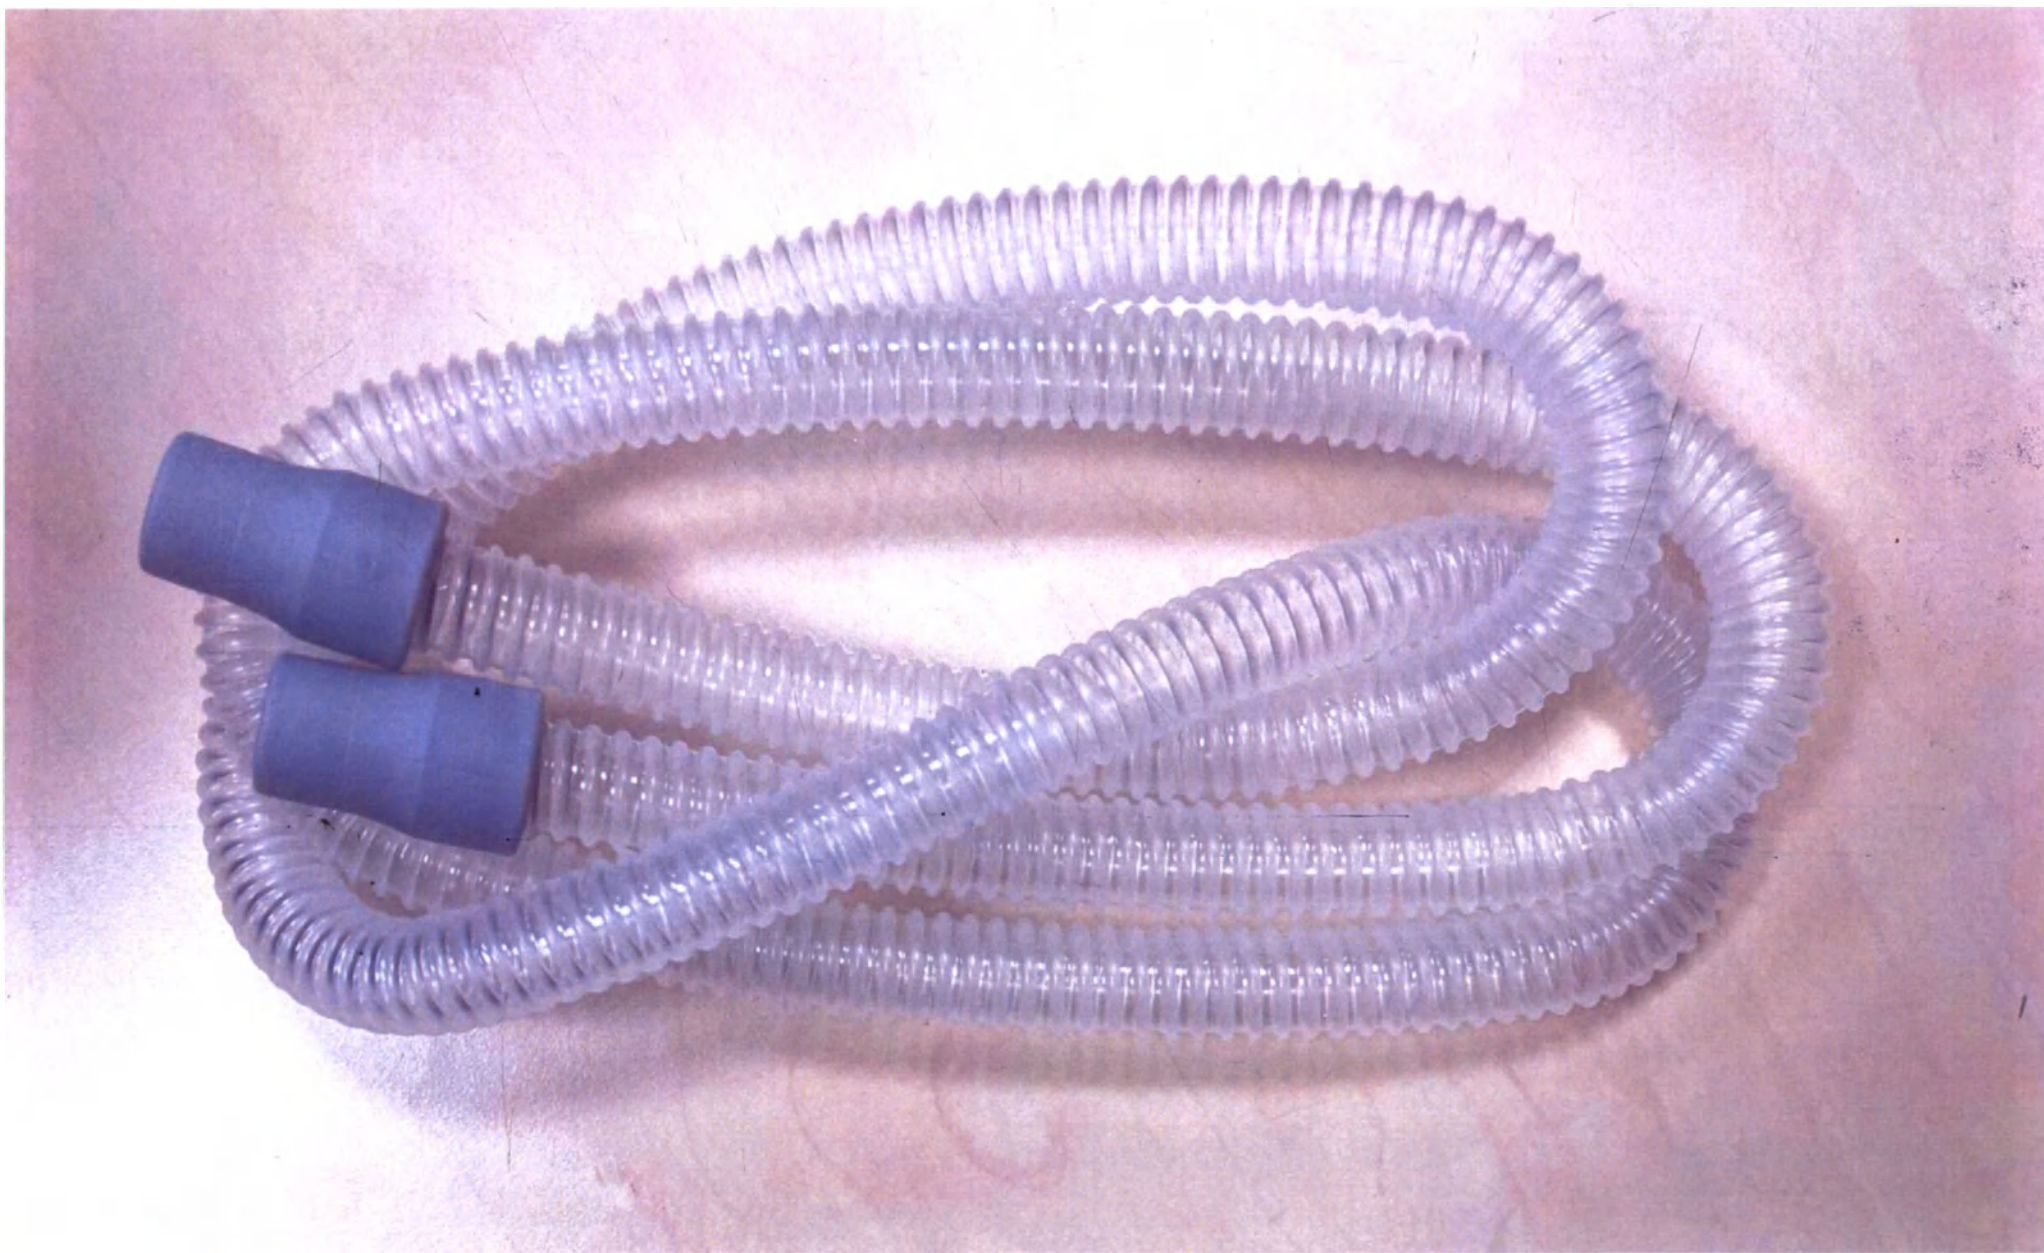

12. Контур пациента односоставной диаметром 15 мм, подогреваемый.

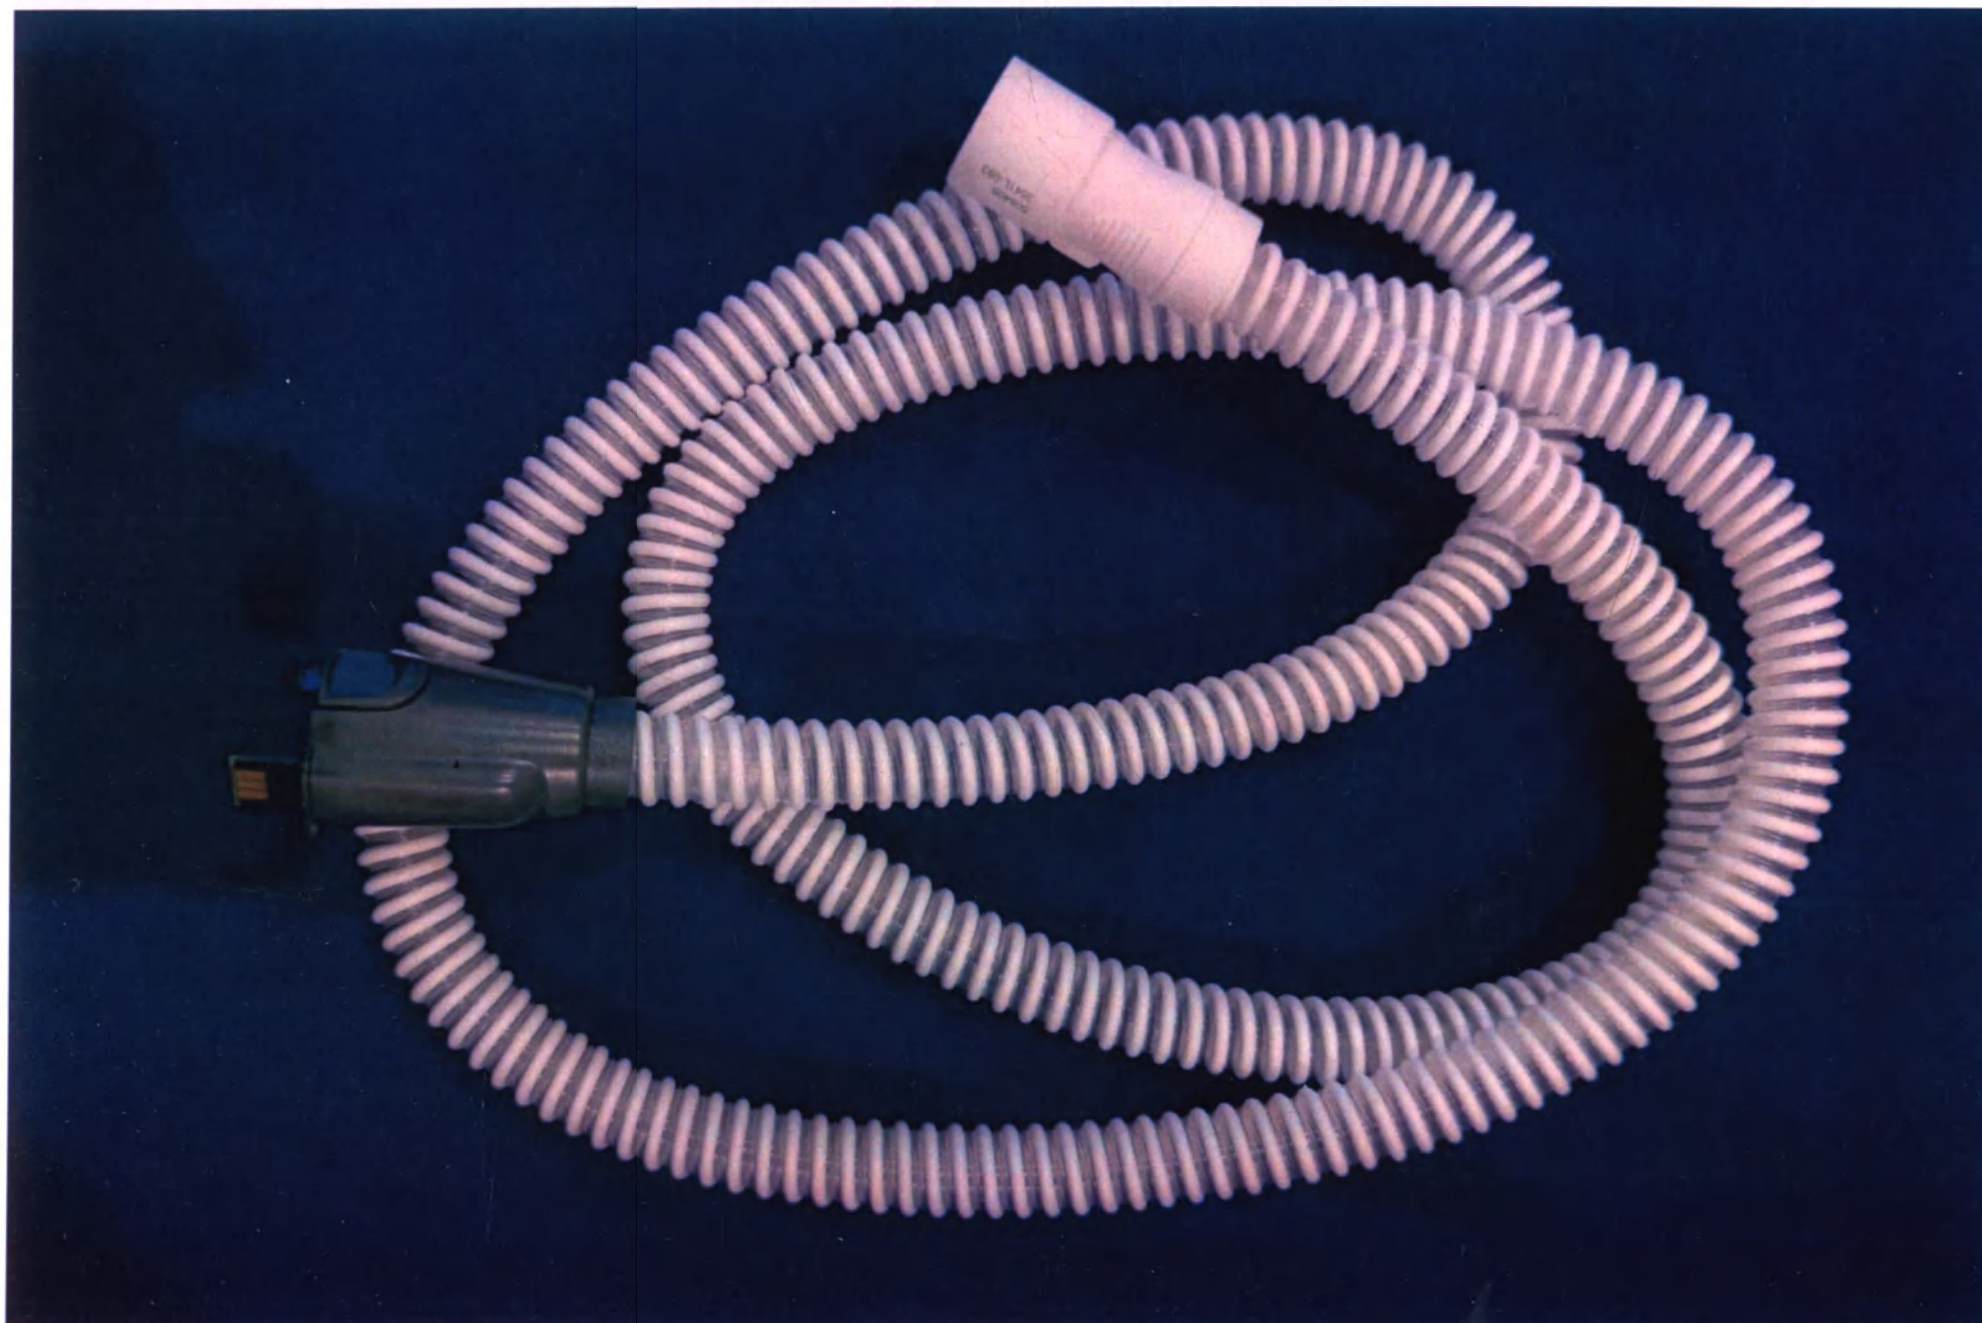


13. Контур пациента одноставной диаметром 22 мм, с фильтром антибактериальным низкого сопротивления, индивидуальный.

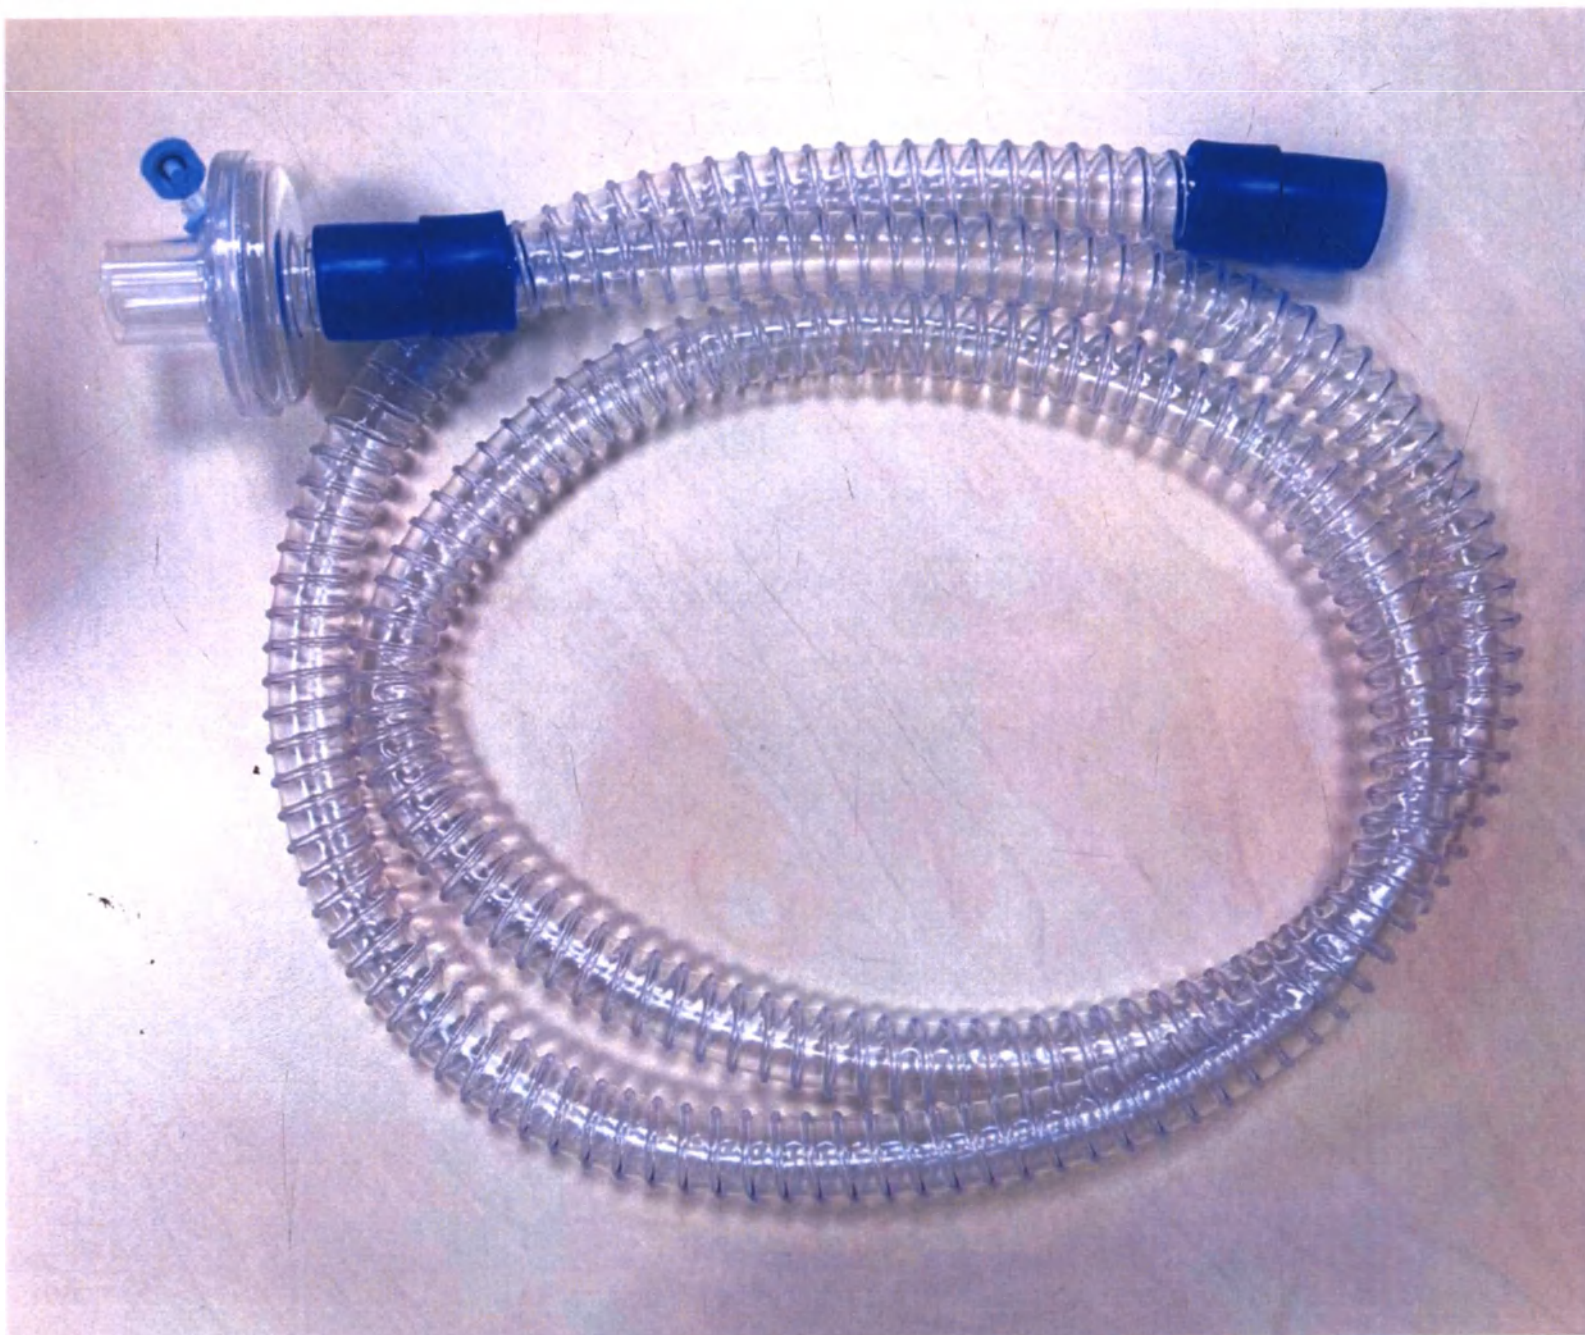



15. Патрубок утечки.

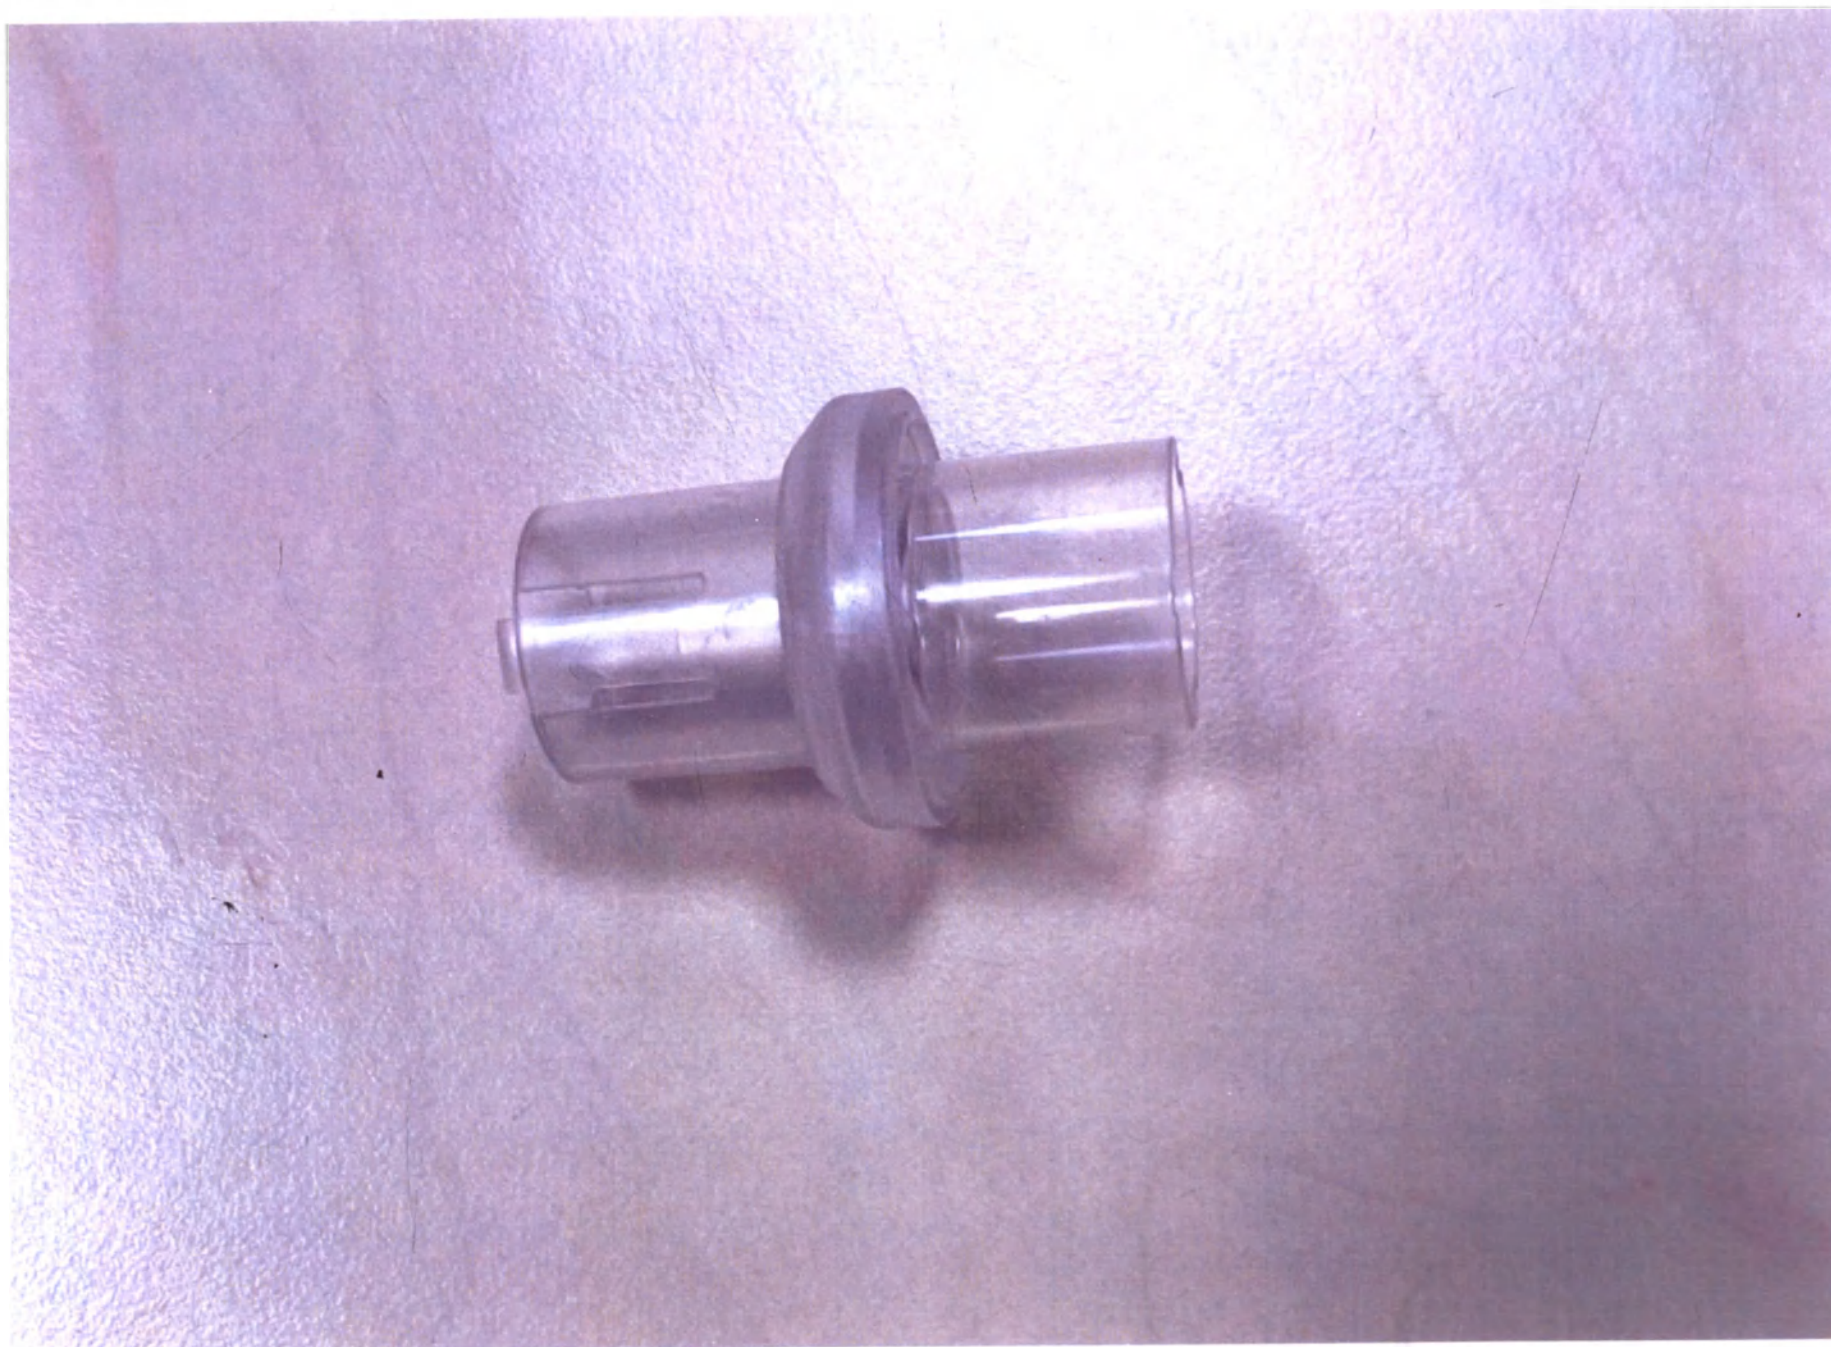









19. Y-кабель для одновременного подключения аппарата к электропитанию переменного и постоянного токов.



20. Кабель для подключения датчика синхронизации по периферическому пульсу.

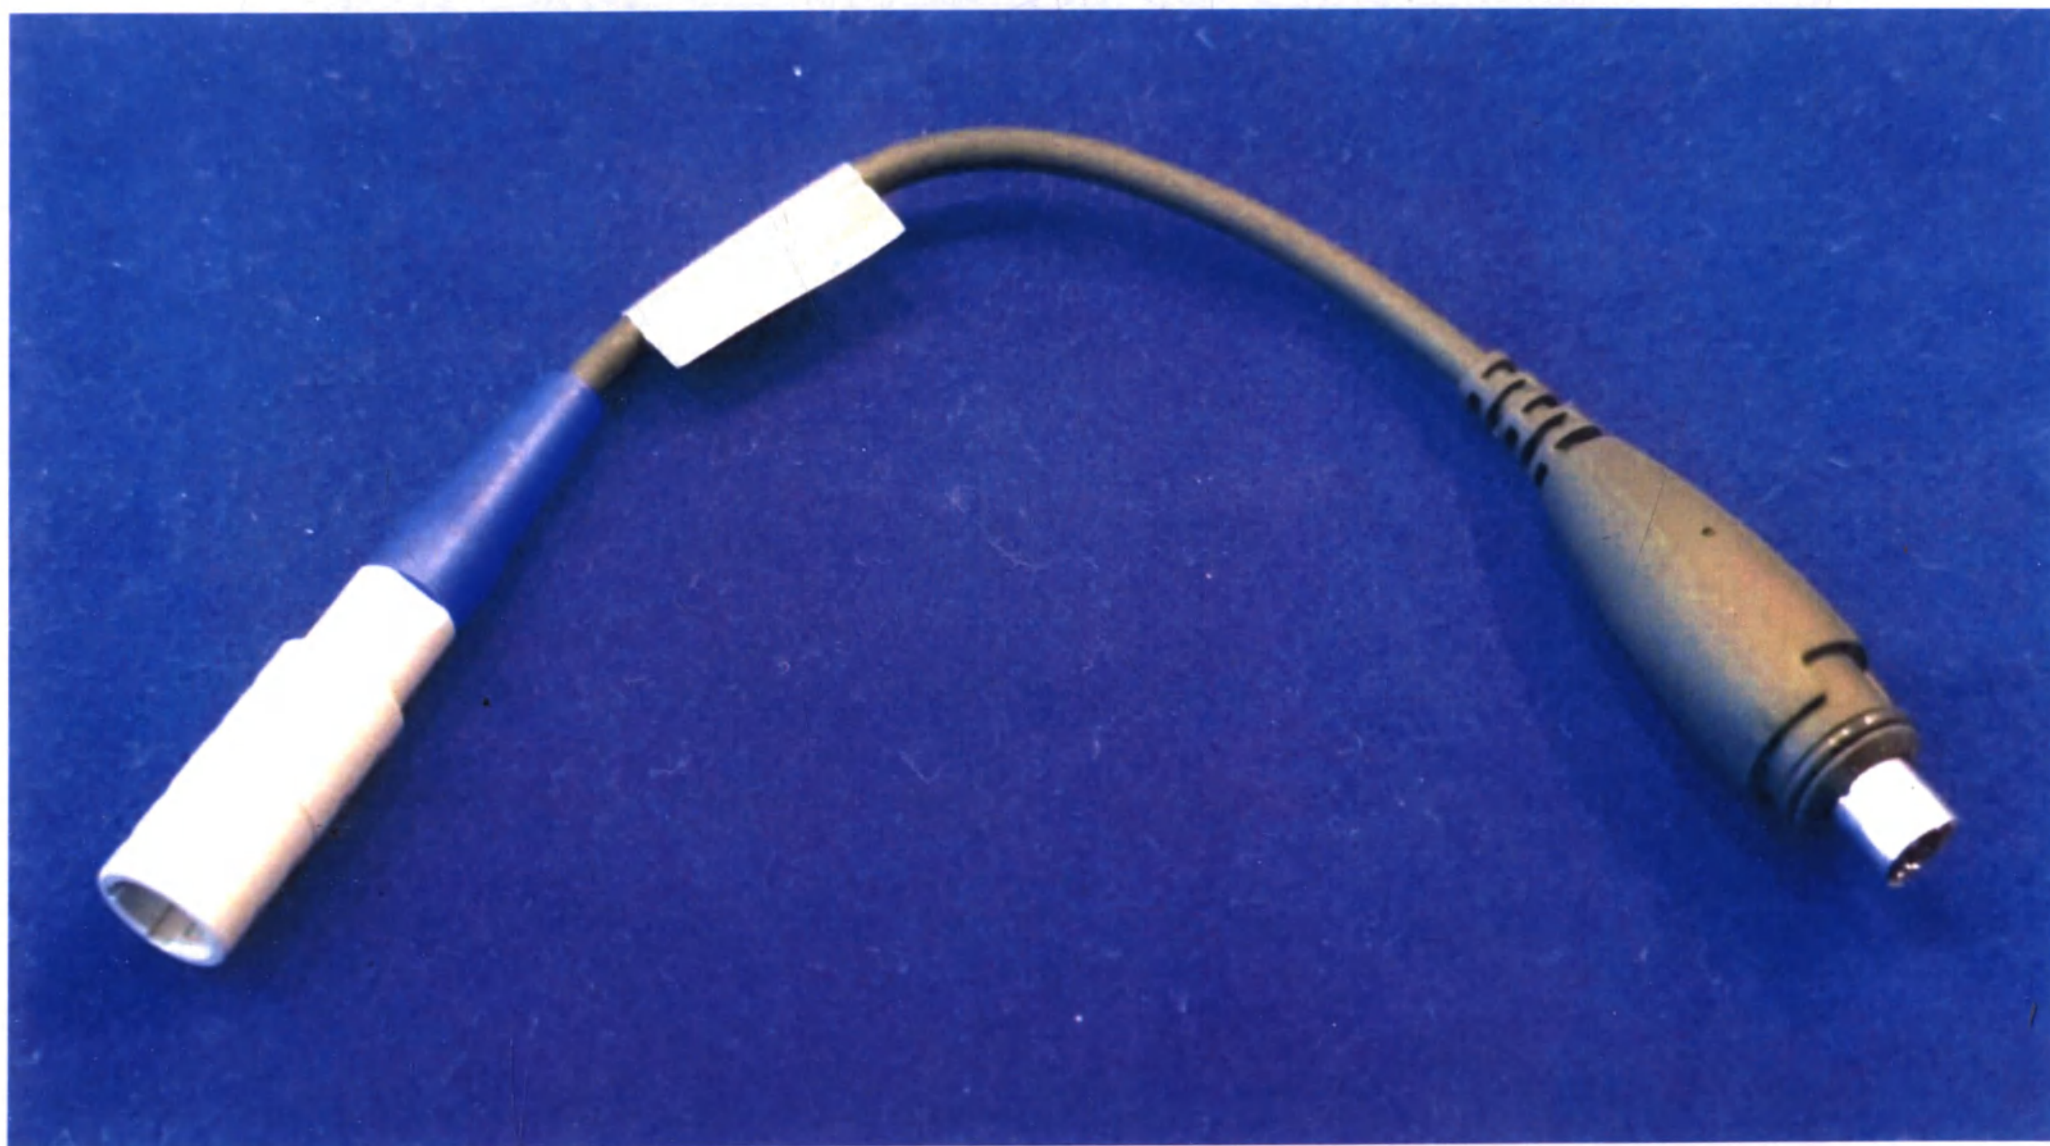

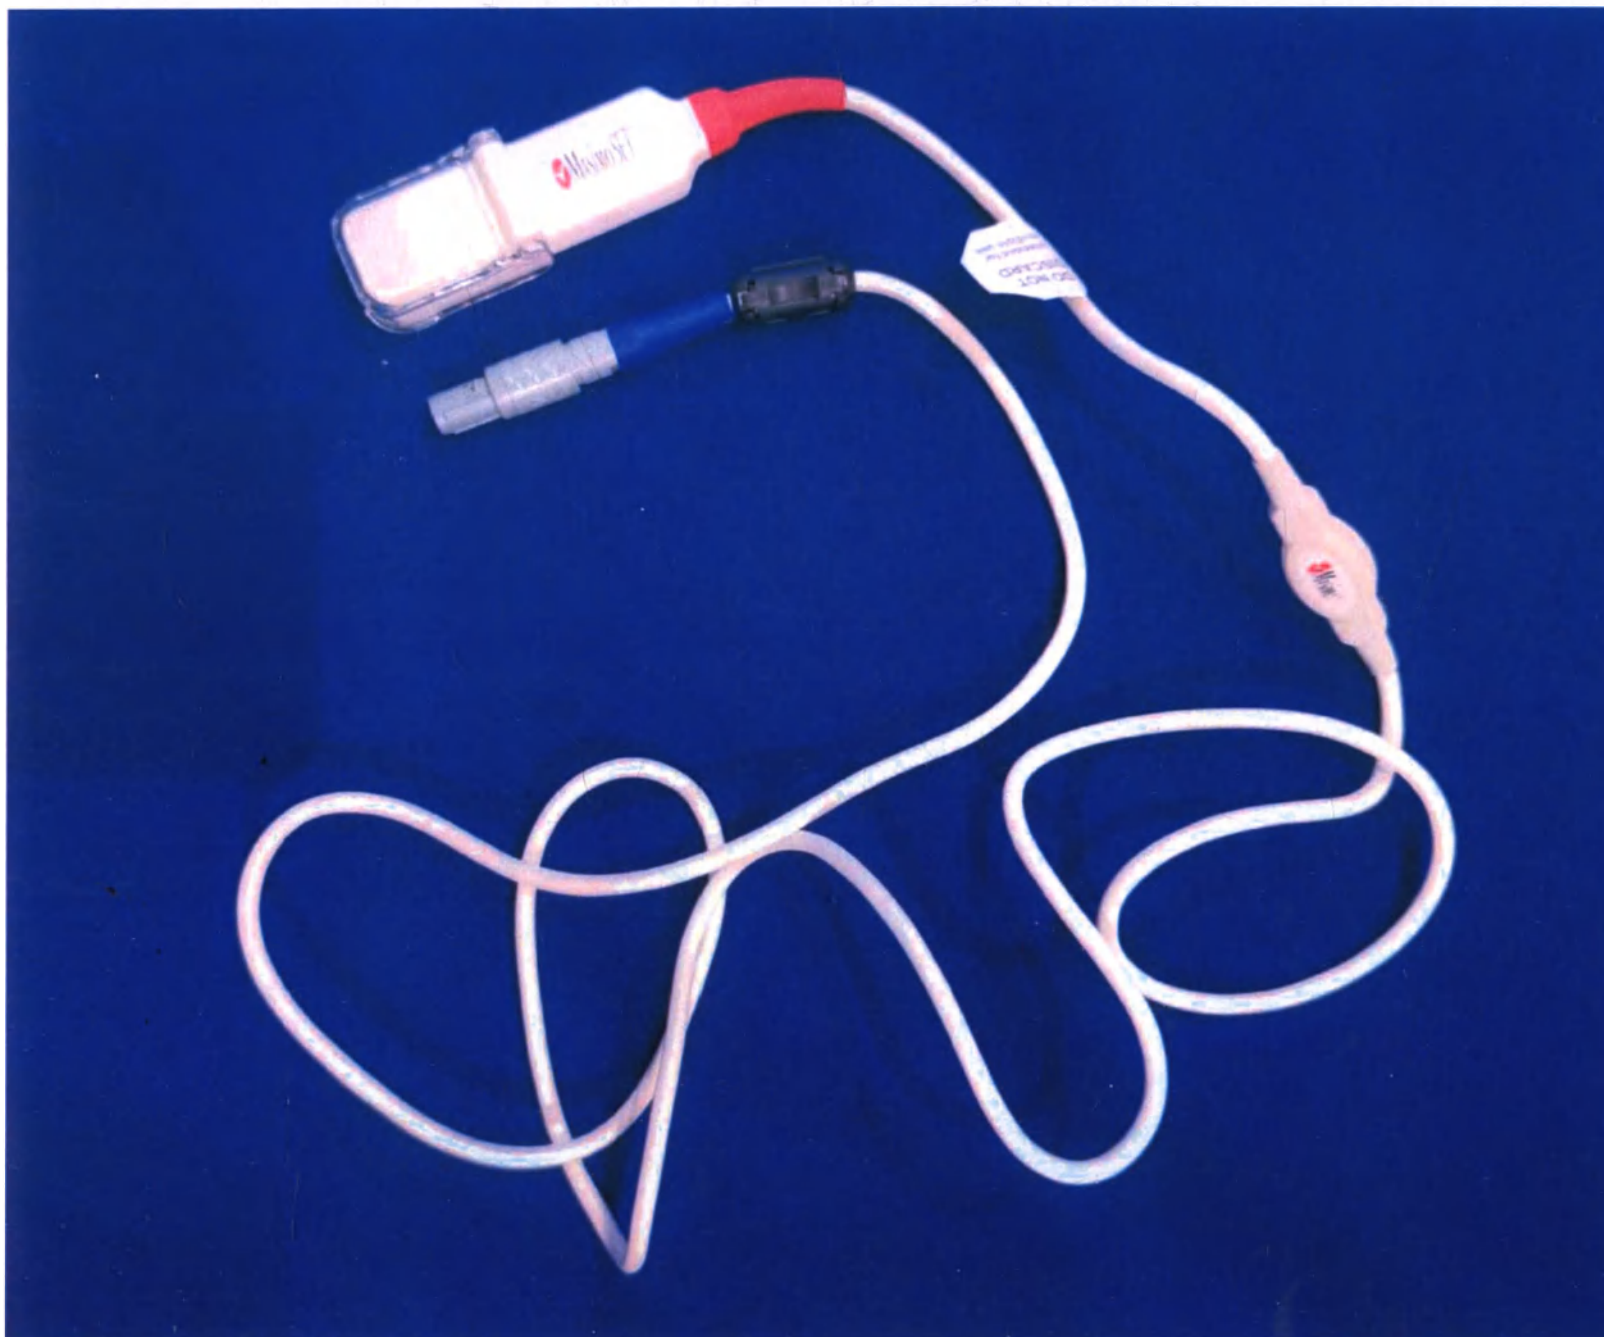

22. Датчик синхронизации по периферическому пульсу, тип клипса, для взрослых.




23. Датчик синхронизации по периферическому пульсу, тип клипса, для детей.







25. Кабель соединительный для батареи аккумуляторной внешней.

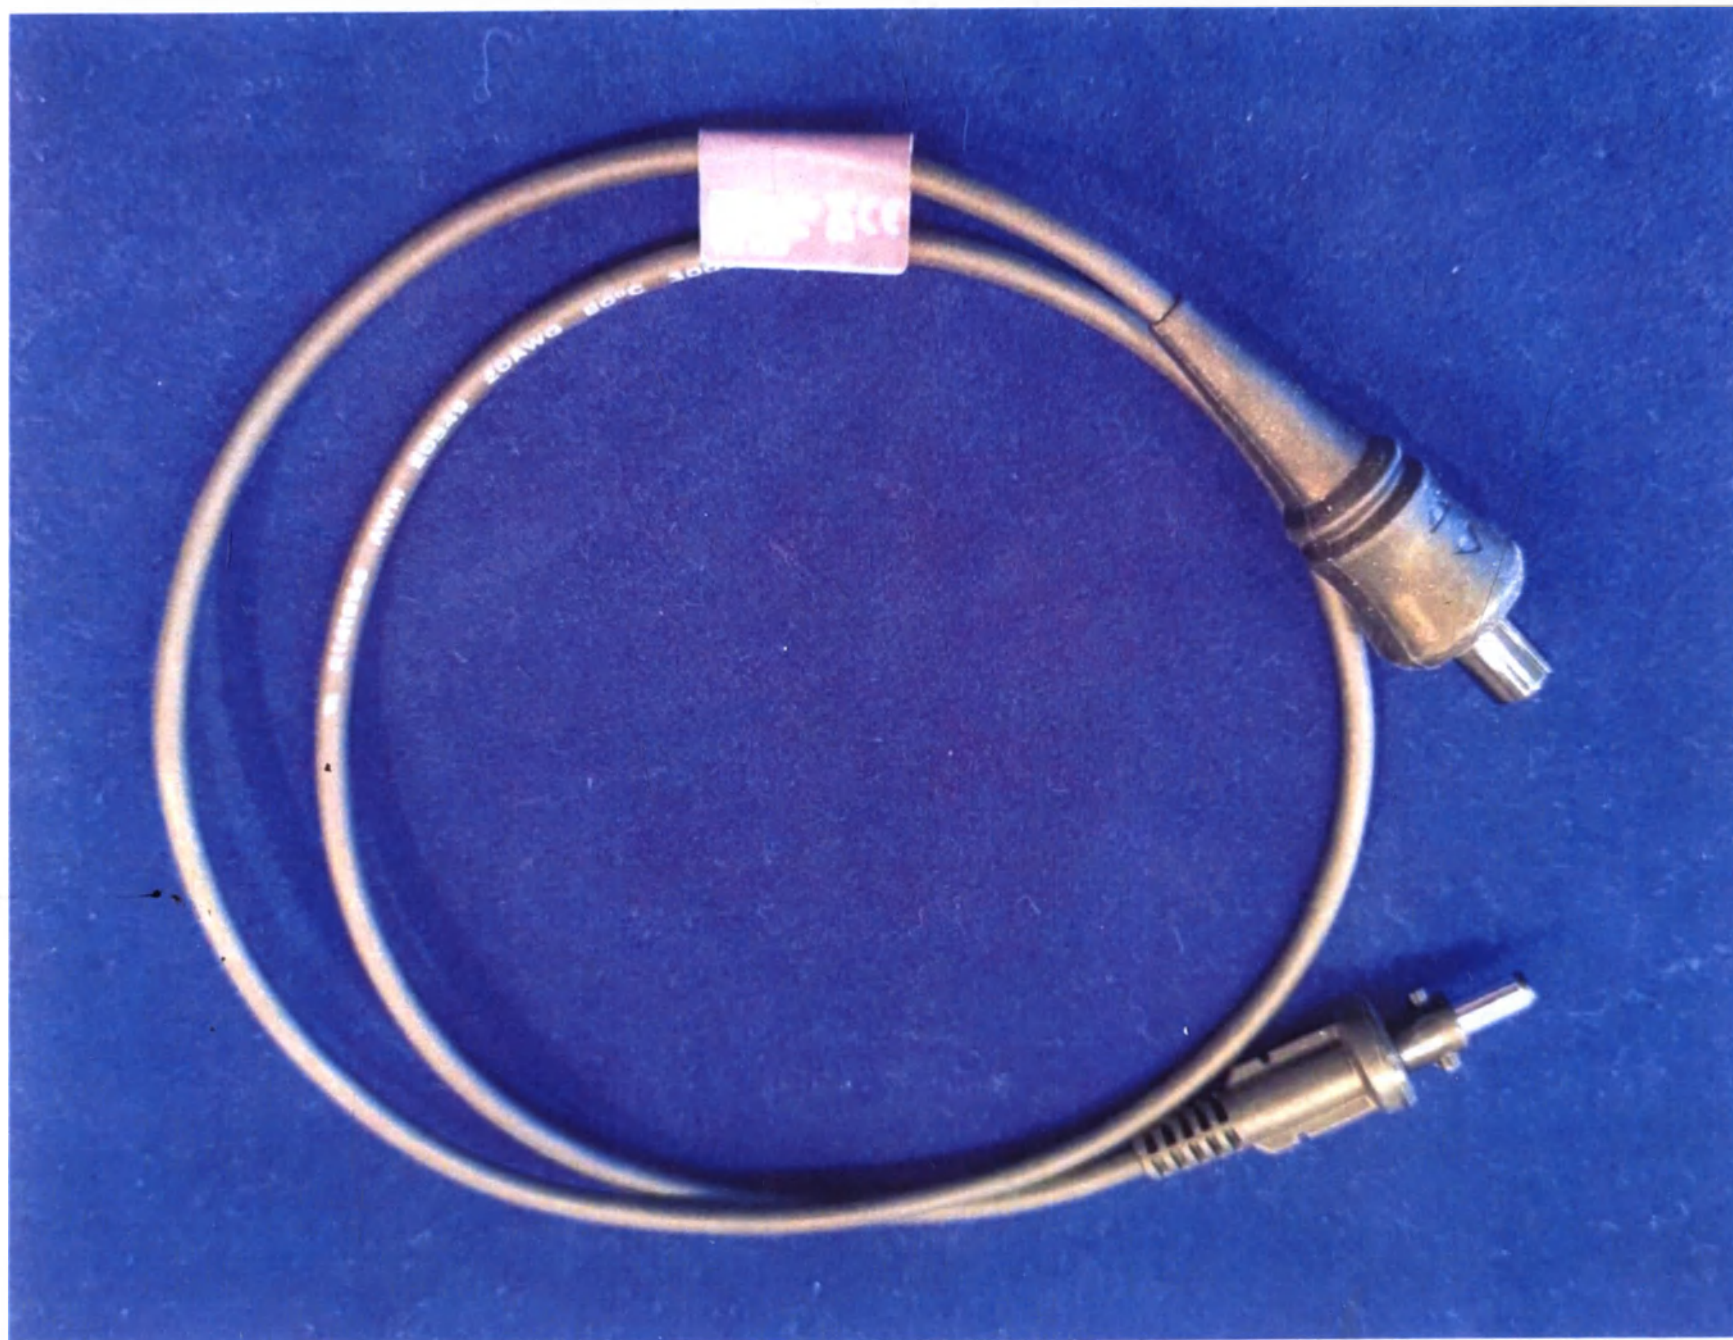






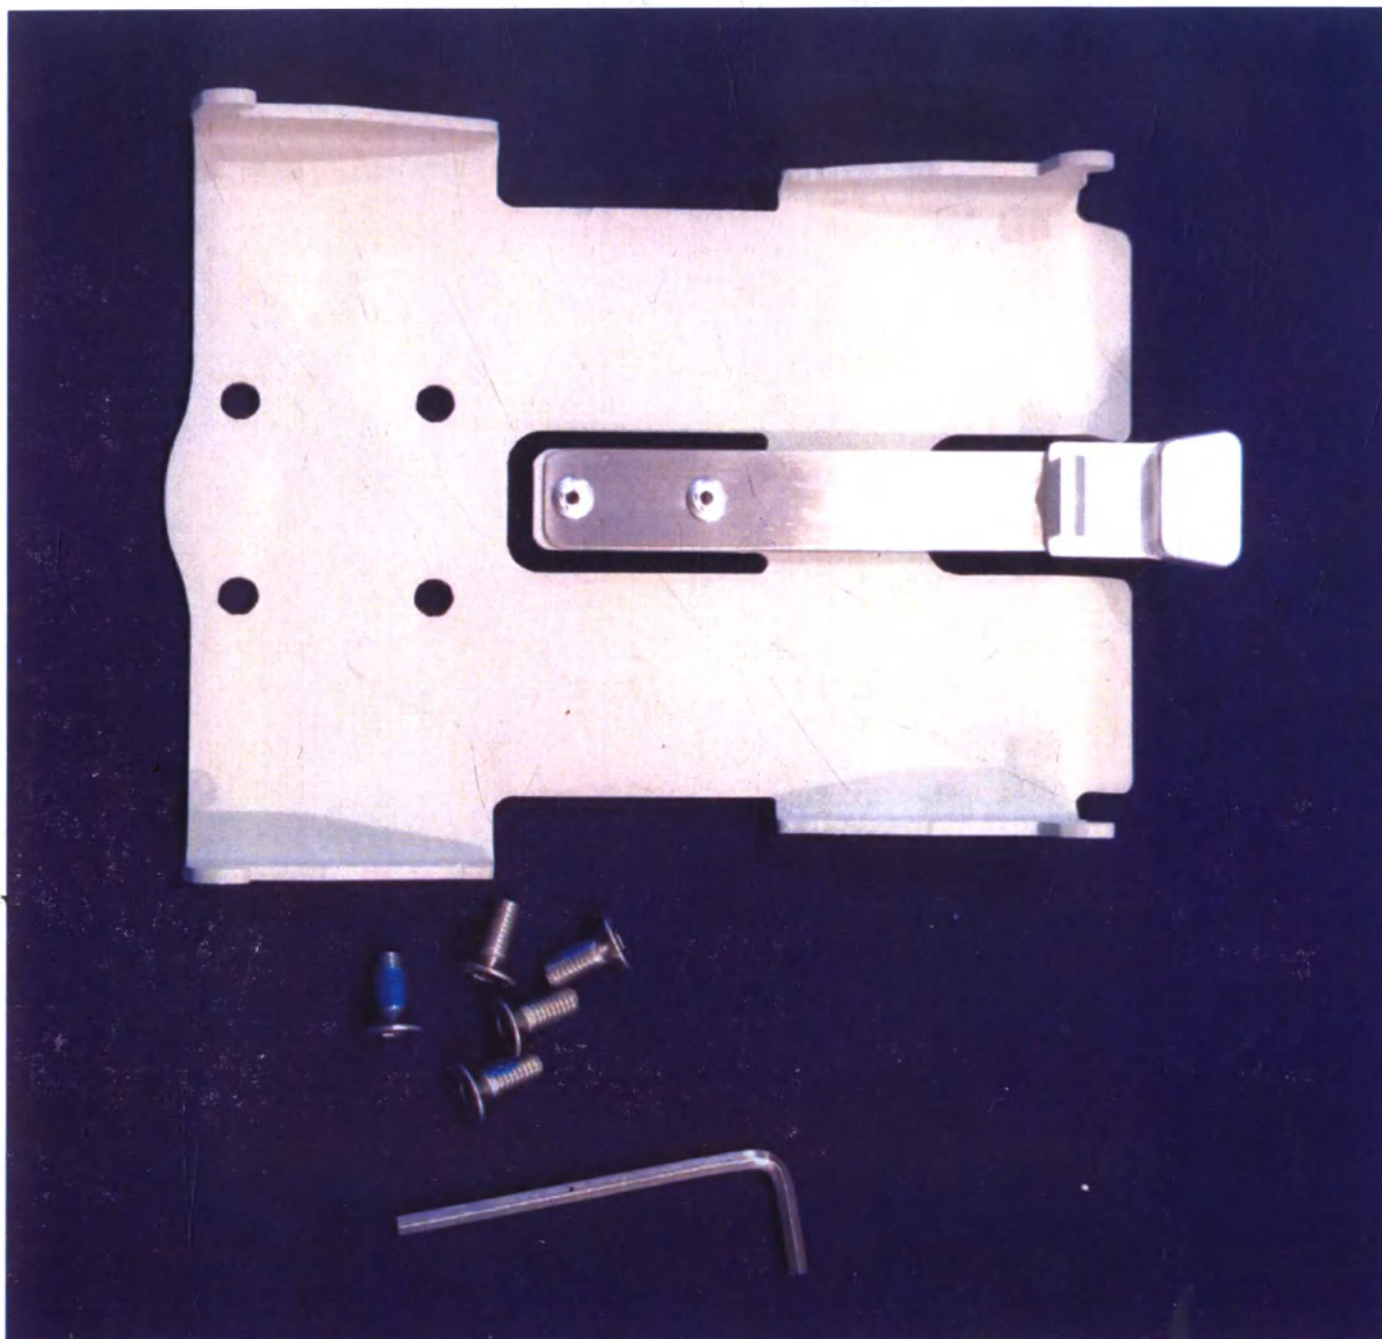


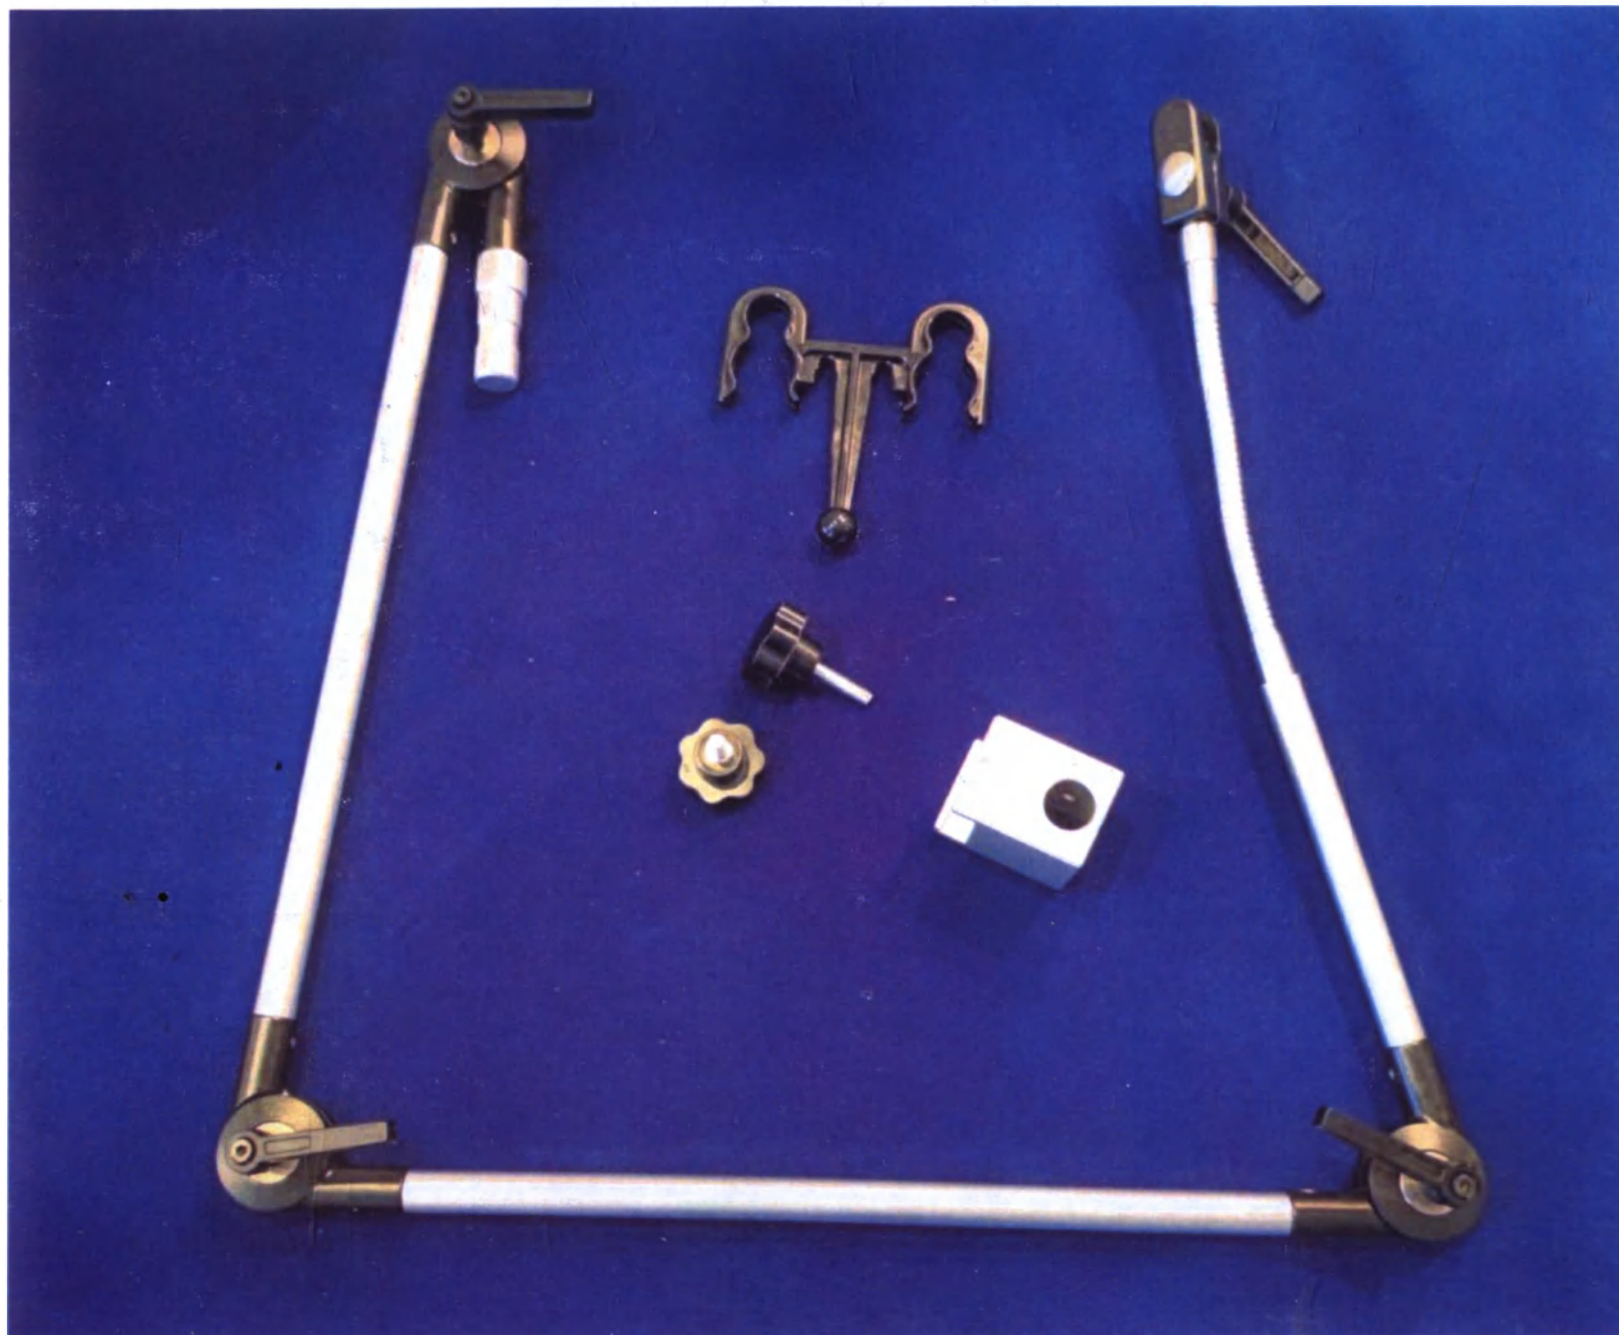

30. Зажим для крепления, универсальный.

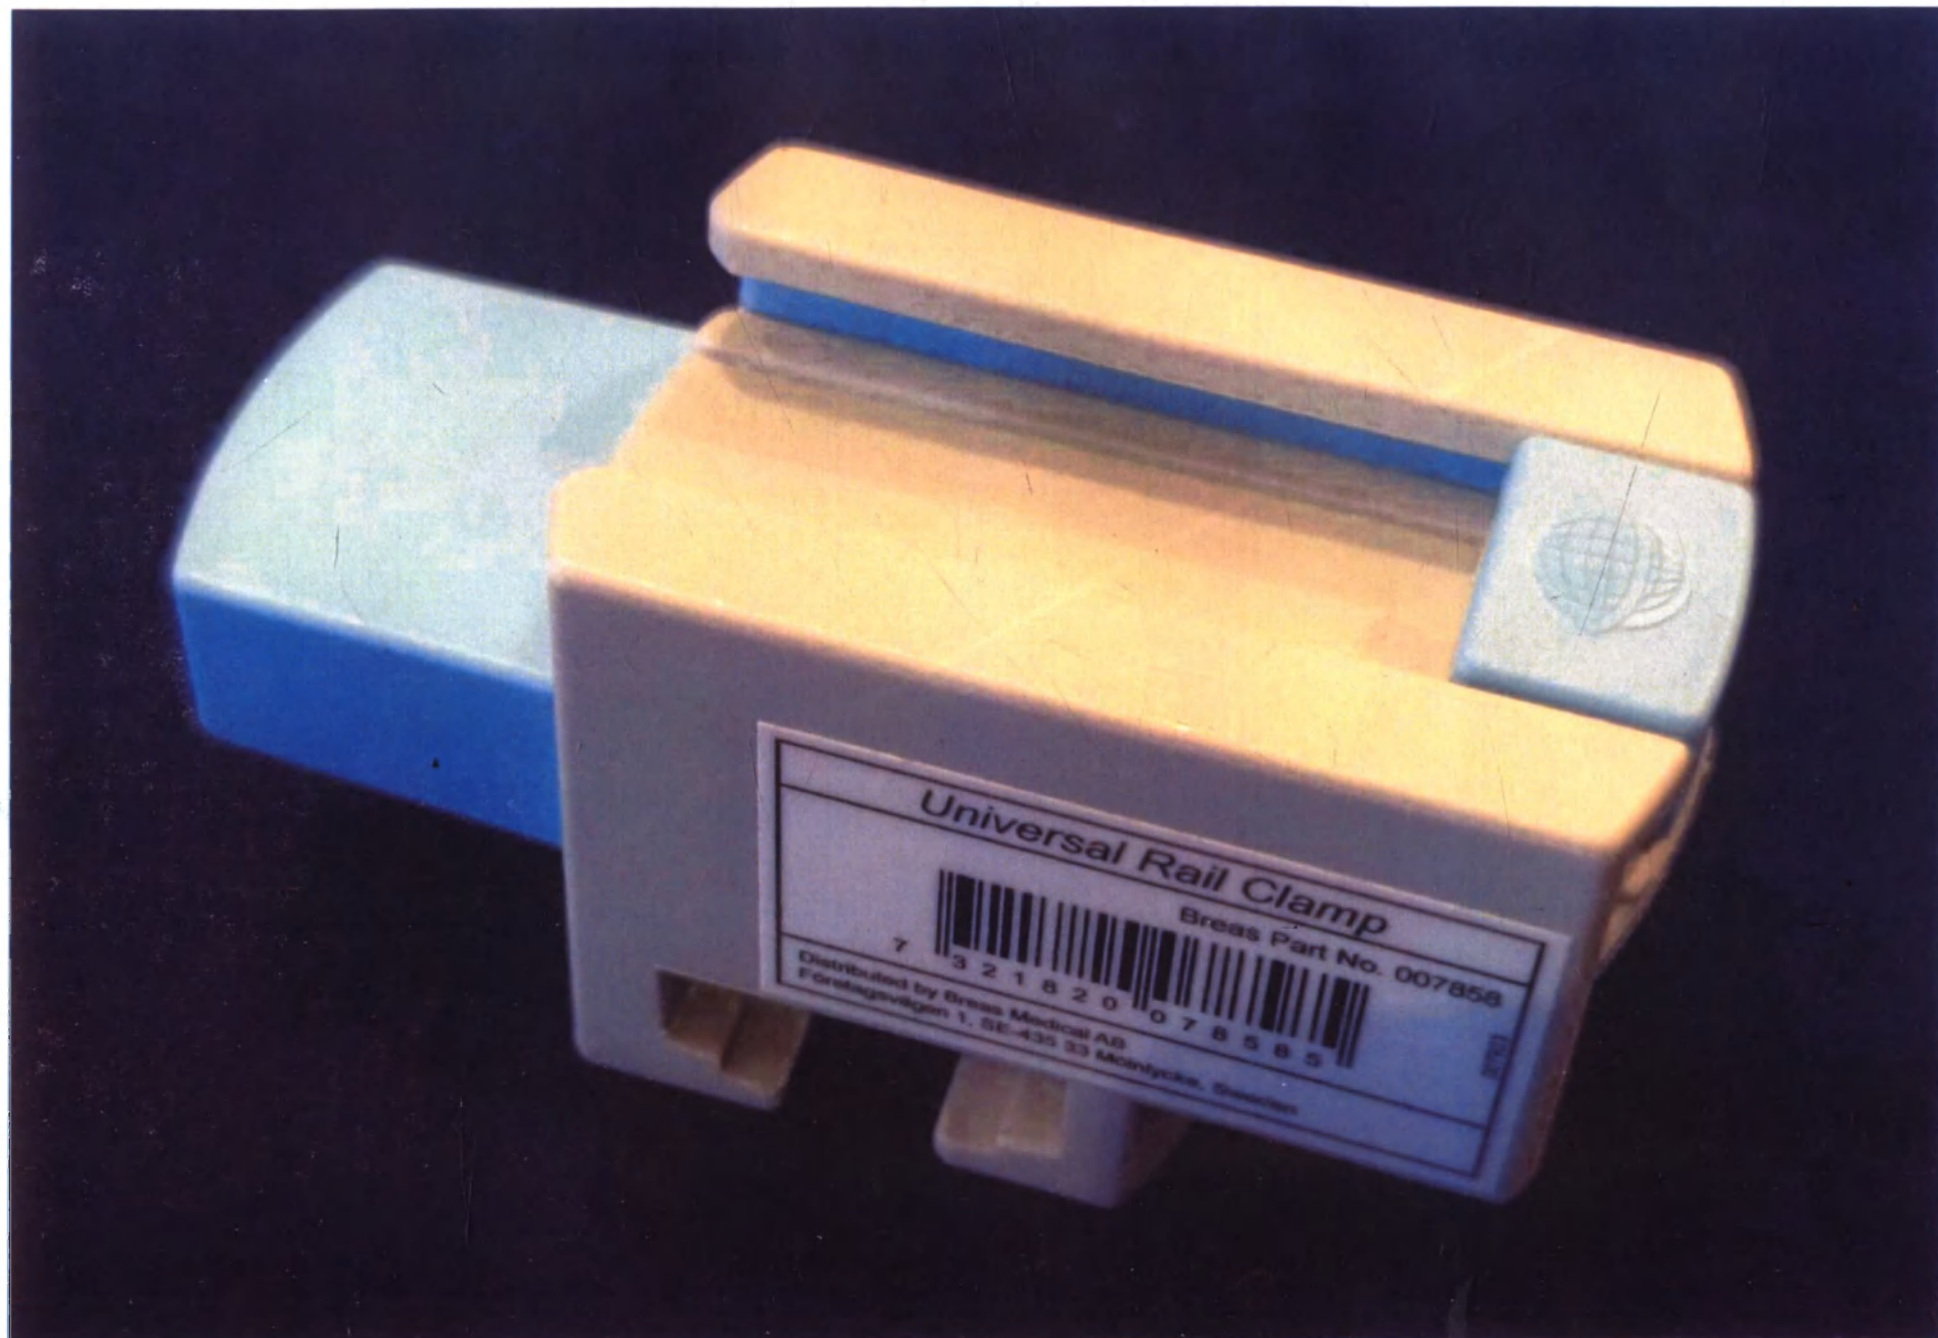

31. Держатель универсальный.

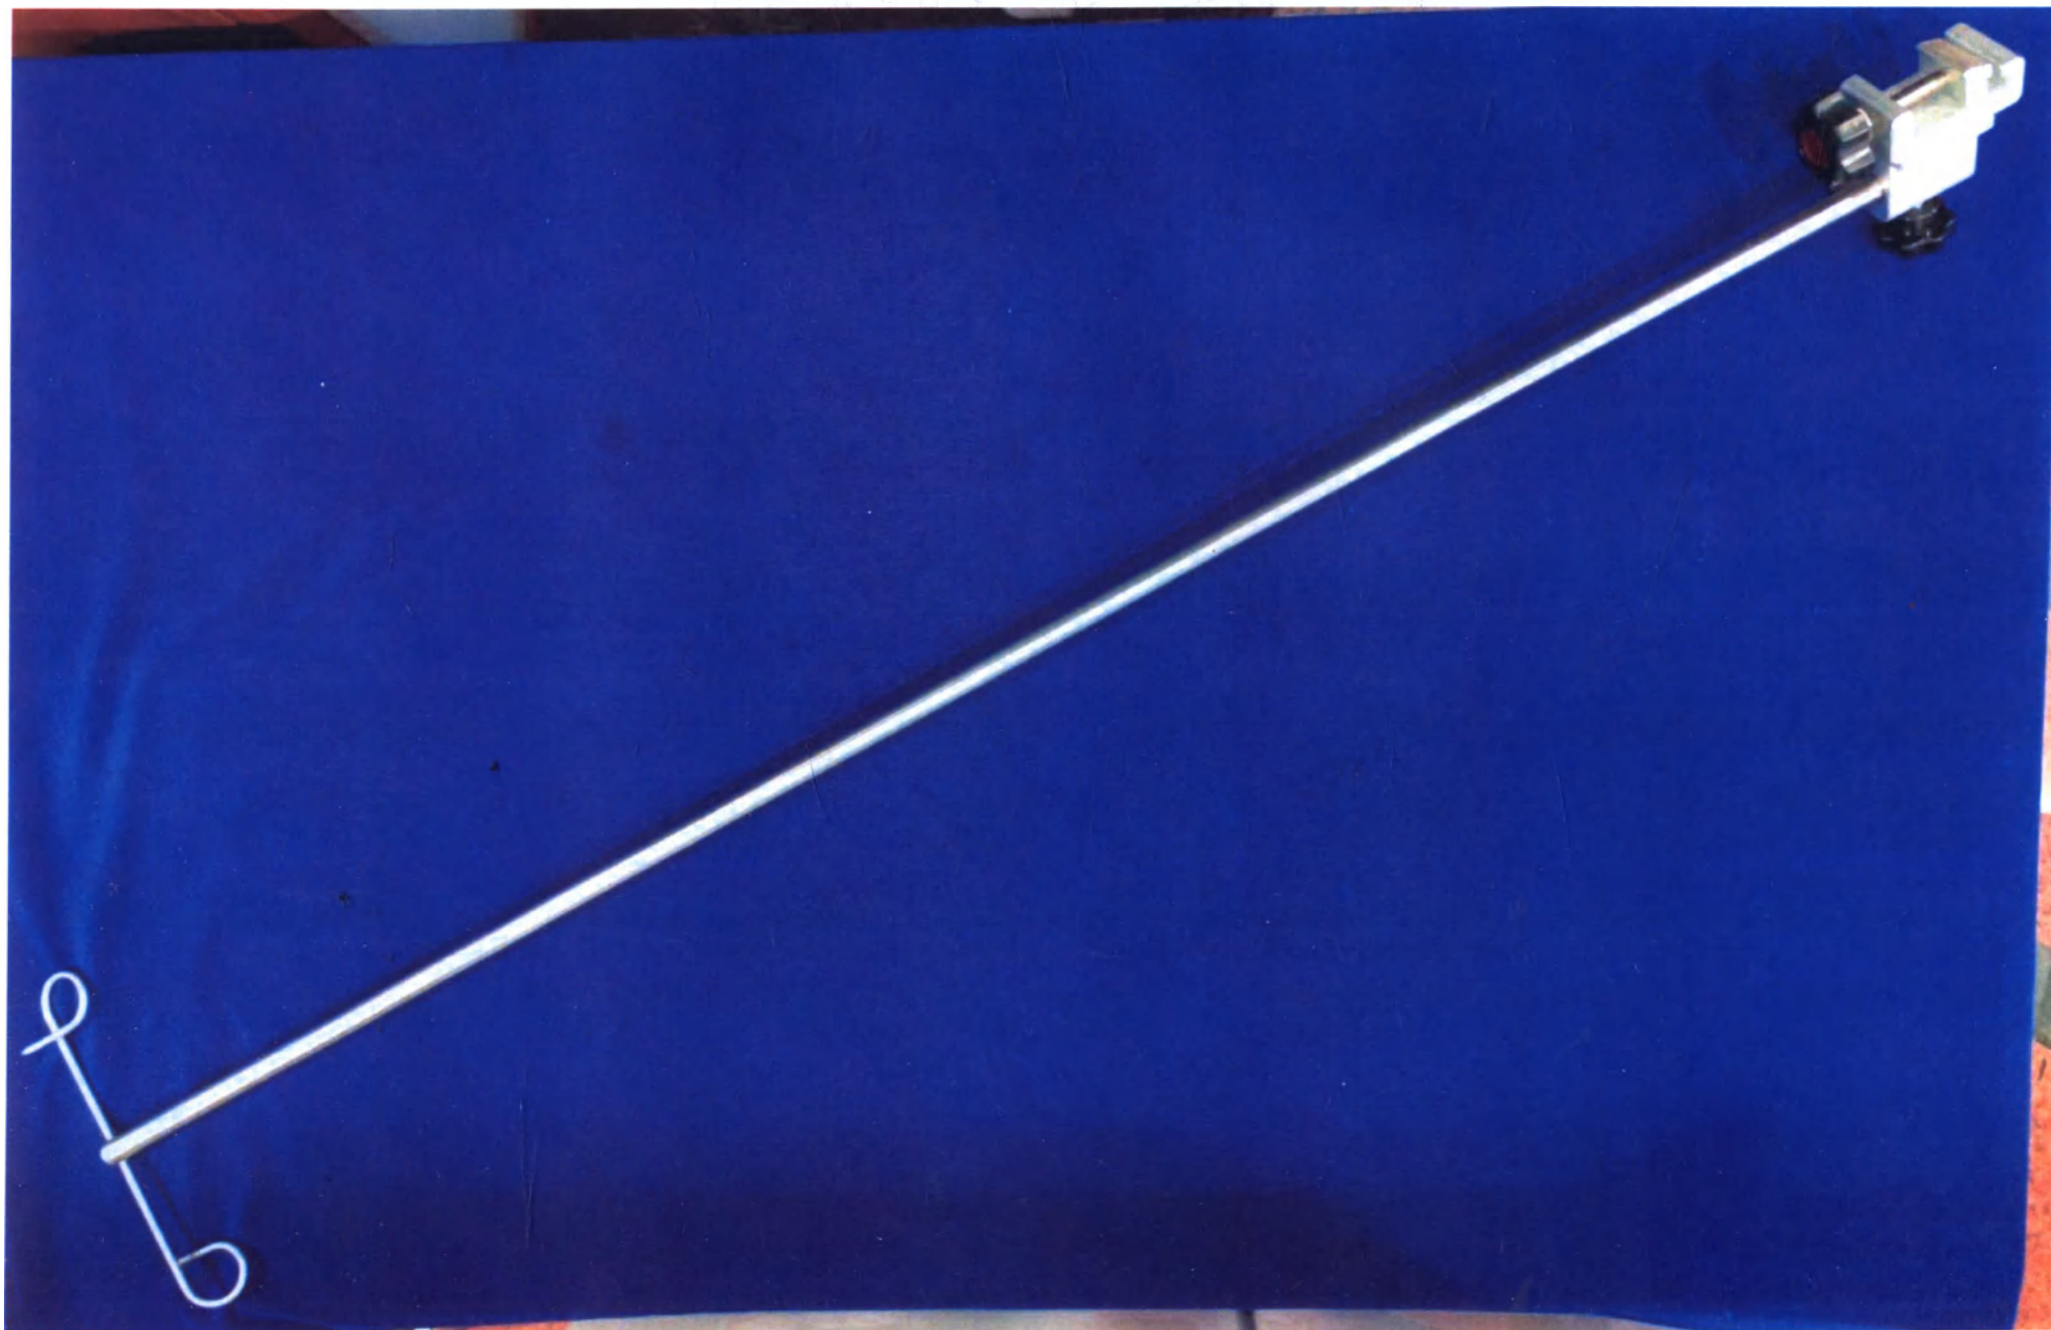

32. Колба увлажнителя.



33. Картридж нагревательный для увлажнителя.



34. Сумка транспортная батареи аккумуляторной внешней.





36. Лёгкая транспортная сумка.




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | **VIVO2**
by Break



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
38 (тридцать восемь) листов



Генеральный директор
ООО «С-Инструментс Медикал»

 Д.В.Соколов

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «С-Инструментс Медикал»
Д.В. Соколов



(подпись)
«21» июня 2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Аппарат искусственной вентиляции легких серии Vivo, вариант исполнения Vivo 3.


1. Аппарат искусственной вентиляции легких, вариант исполнения Vivo 3, в составе: 1. Блок аппарата базовый Vivo 3.




2. Крышка обходная, воздушная.




3. Держатель фильтров.

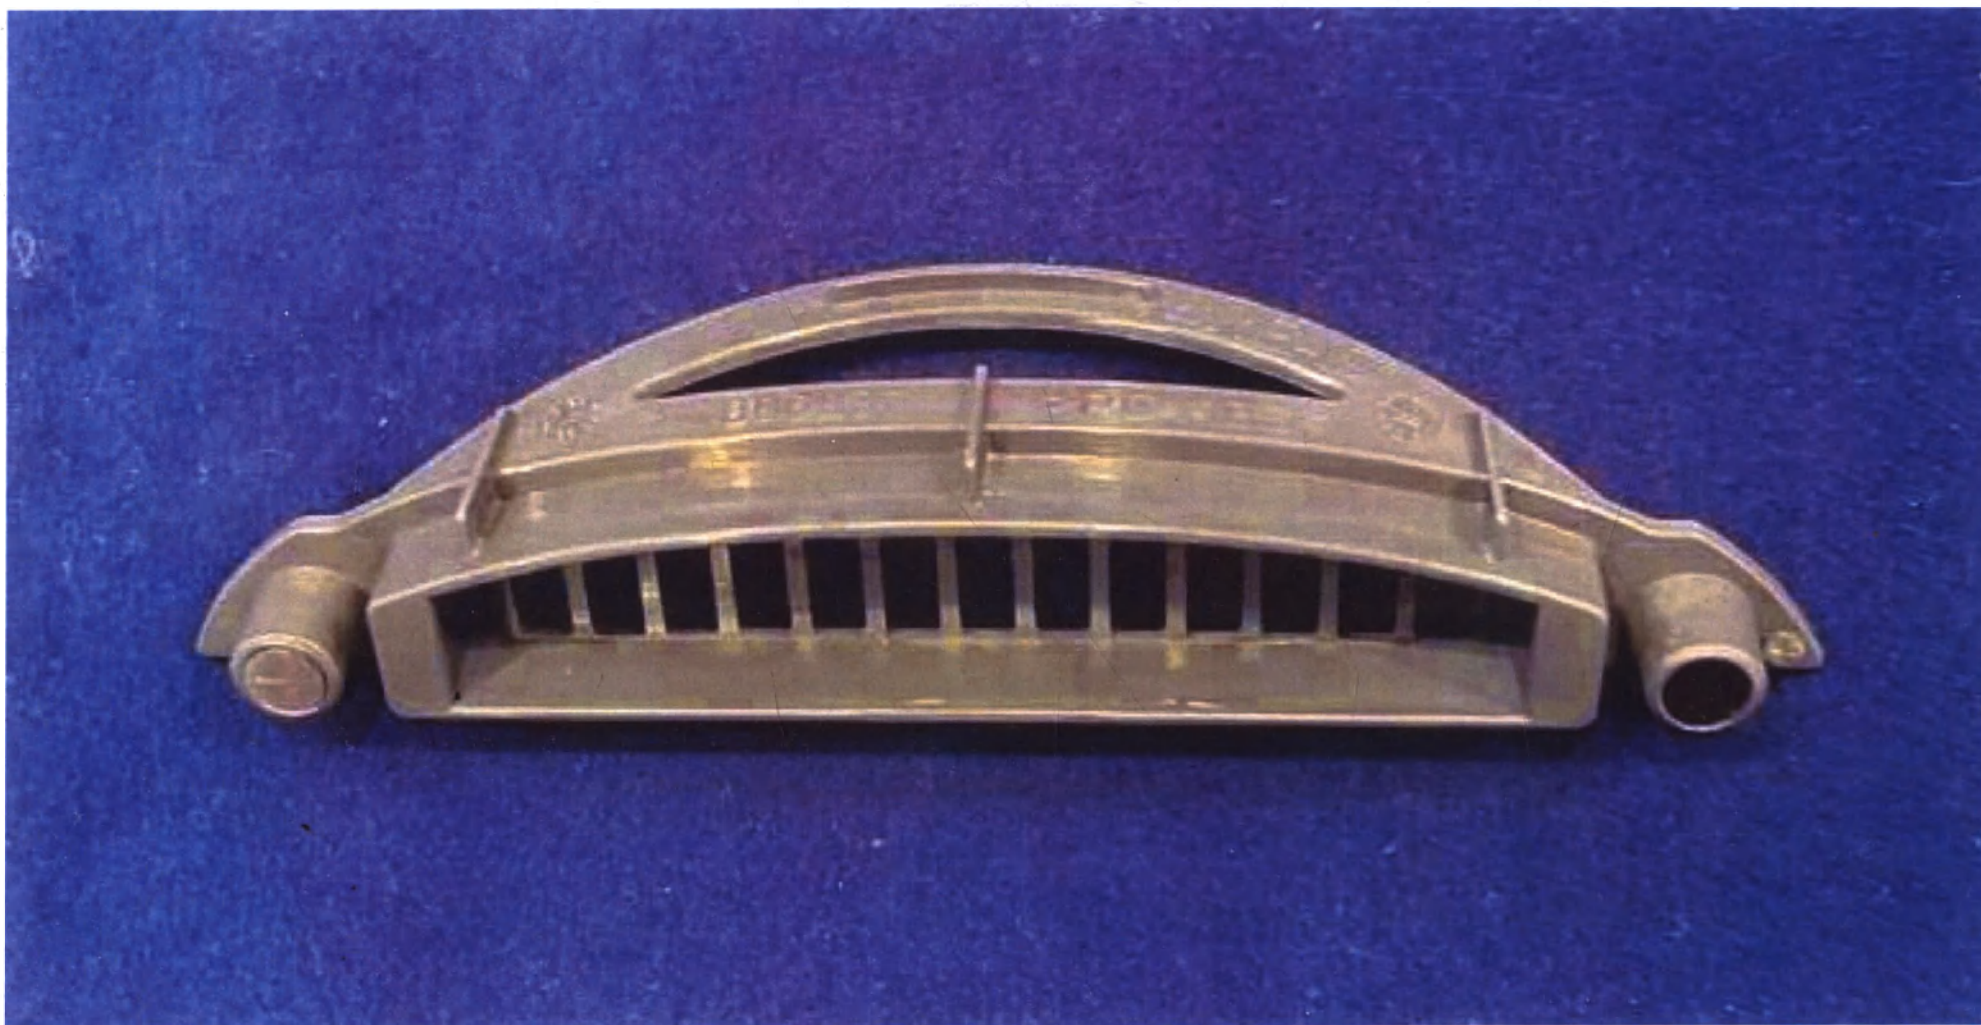


4. Фильтр воздухозаборного отверстия, грубой очистки.

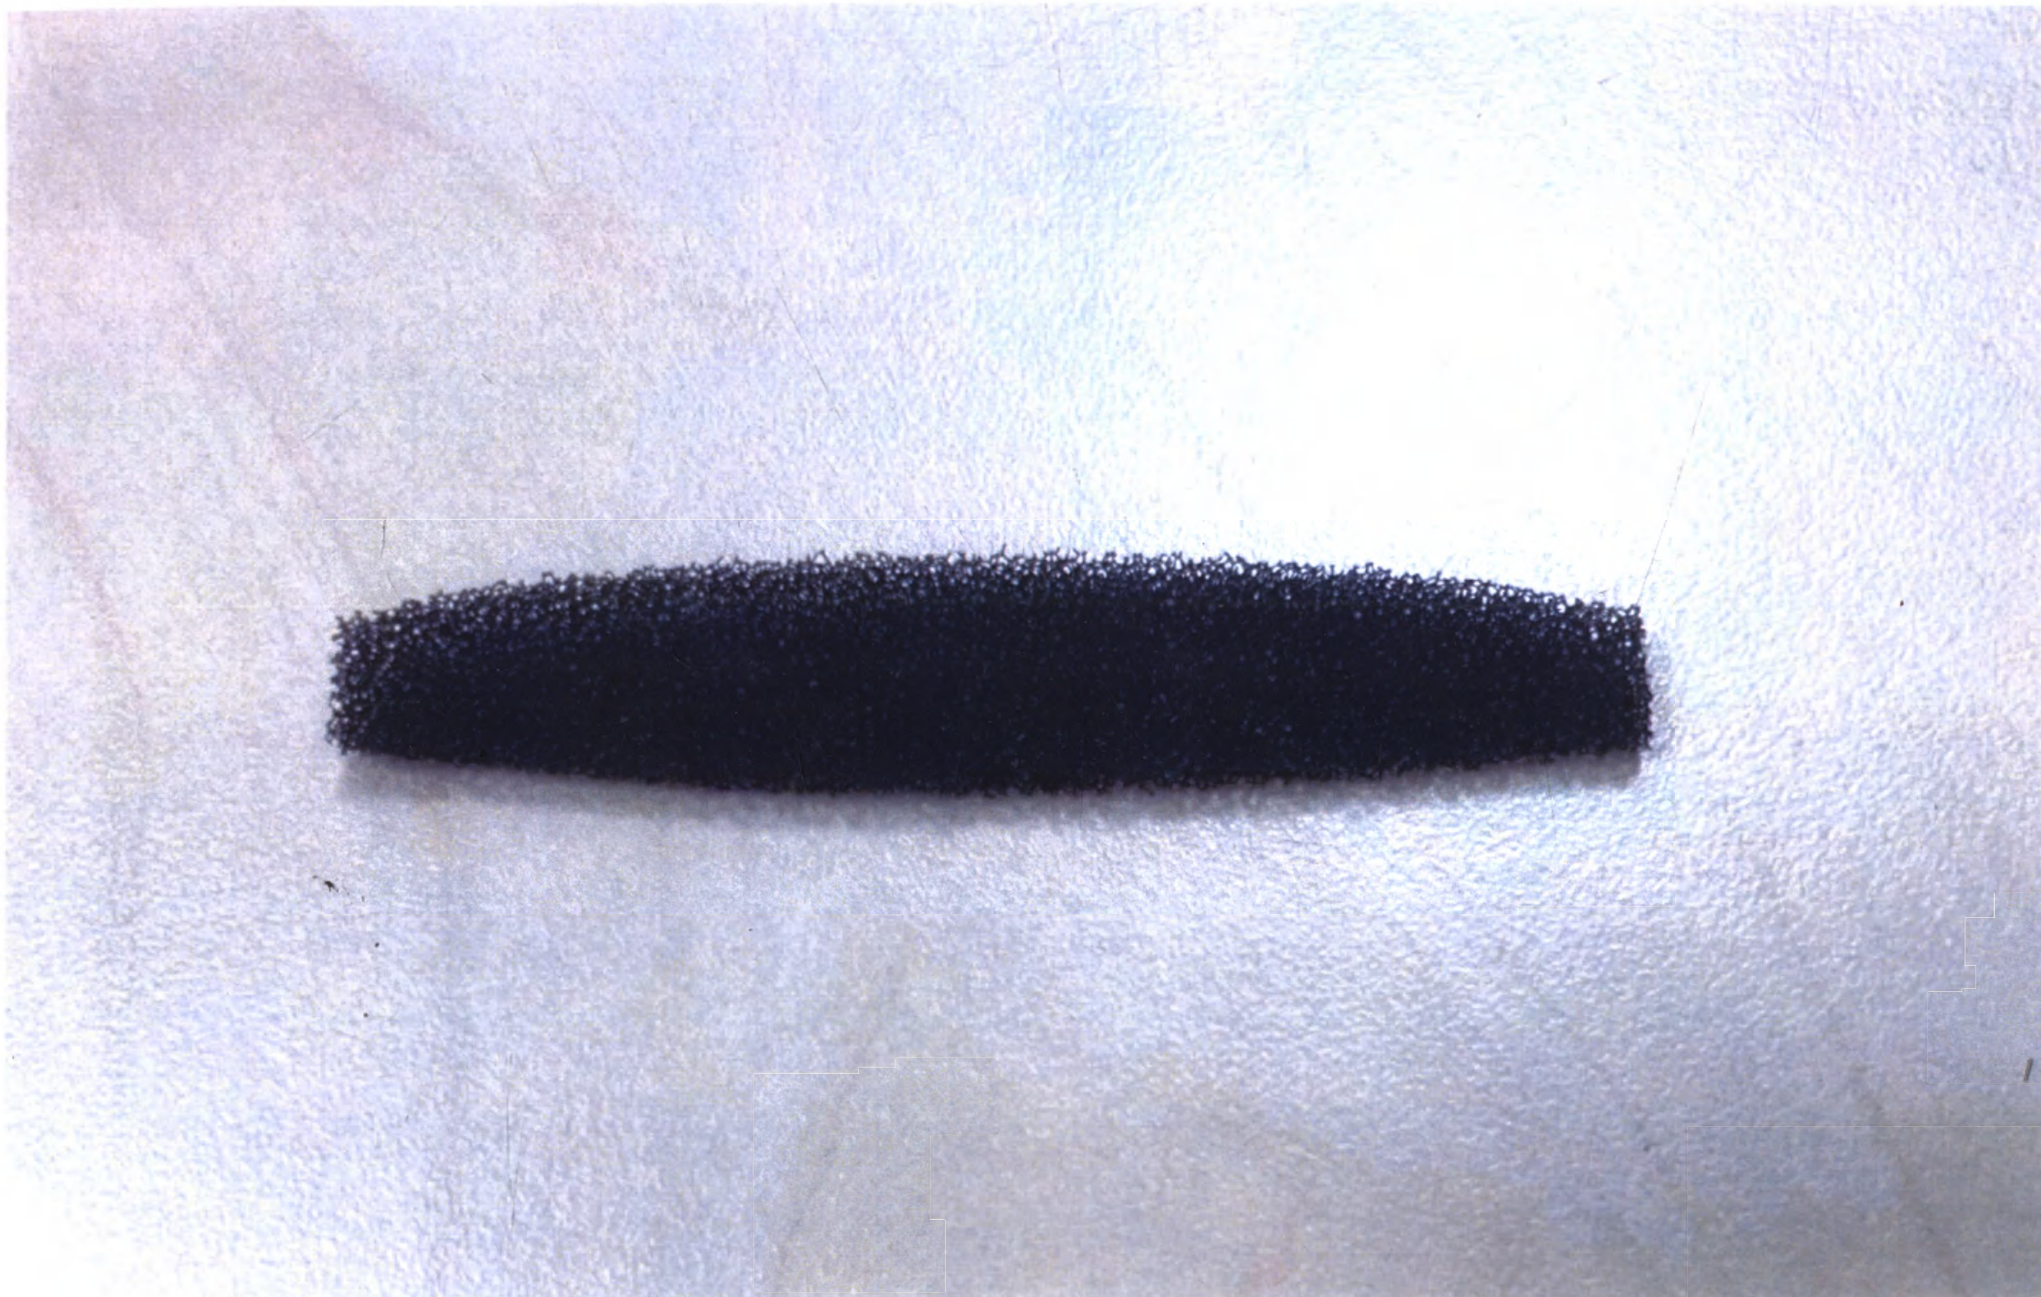


5. Фильтр воздухозаборного отверстия, тонкой очистки.

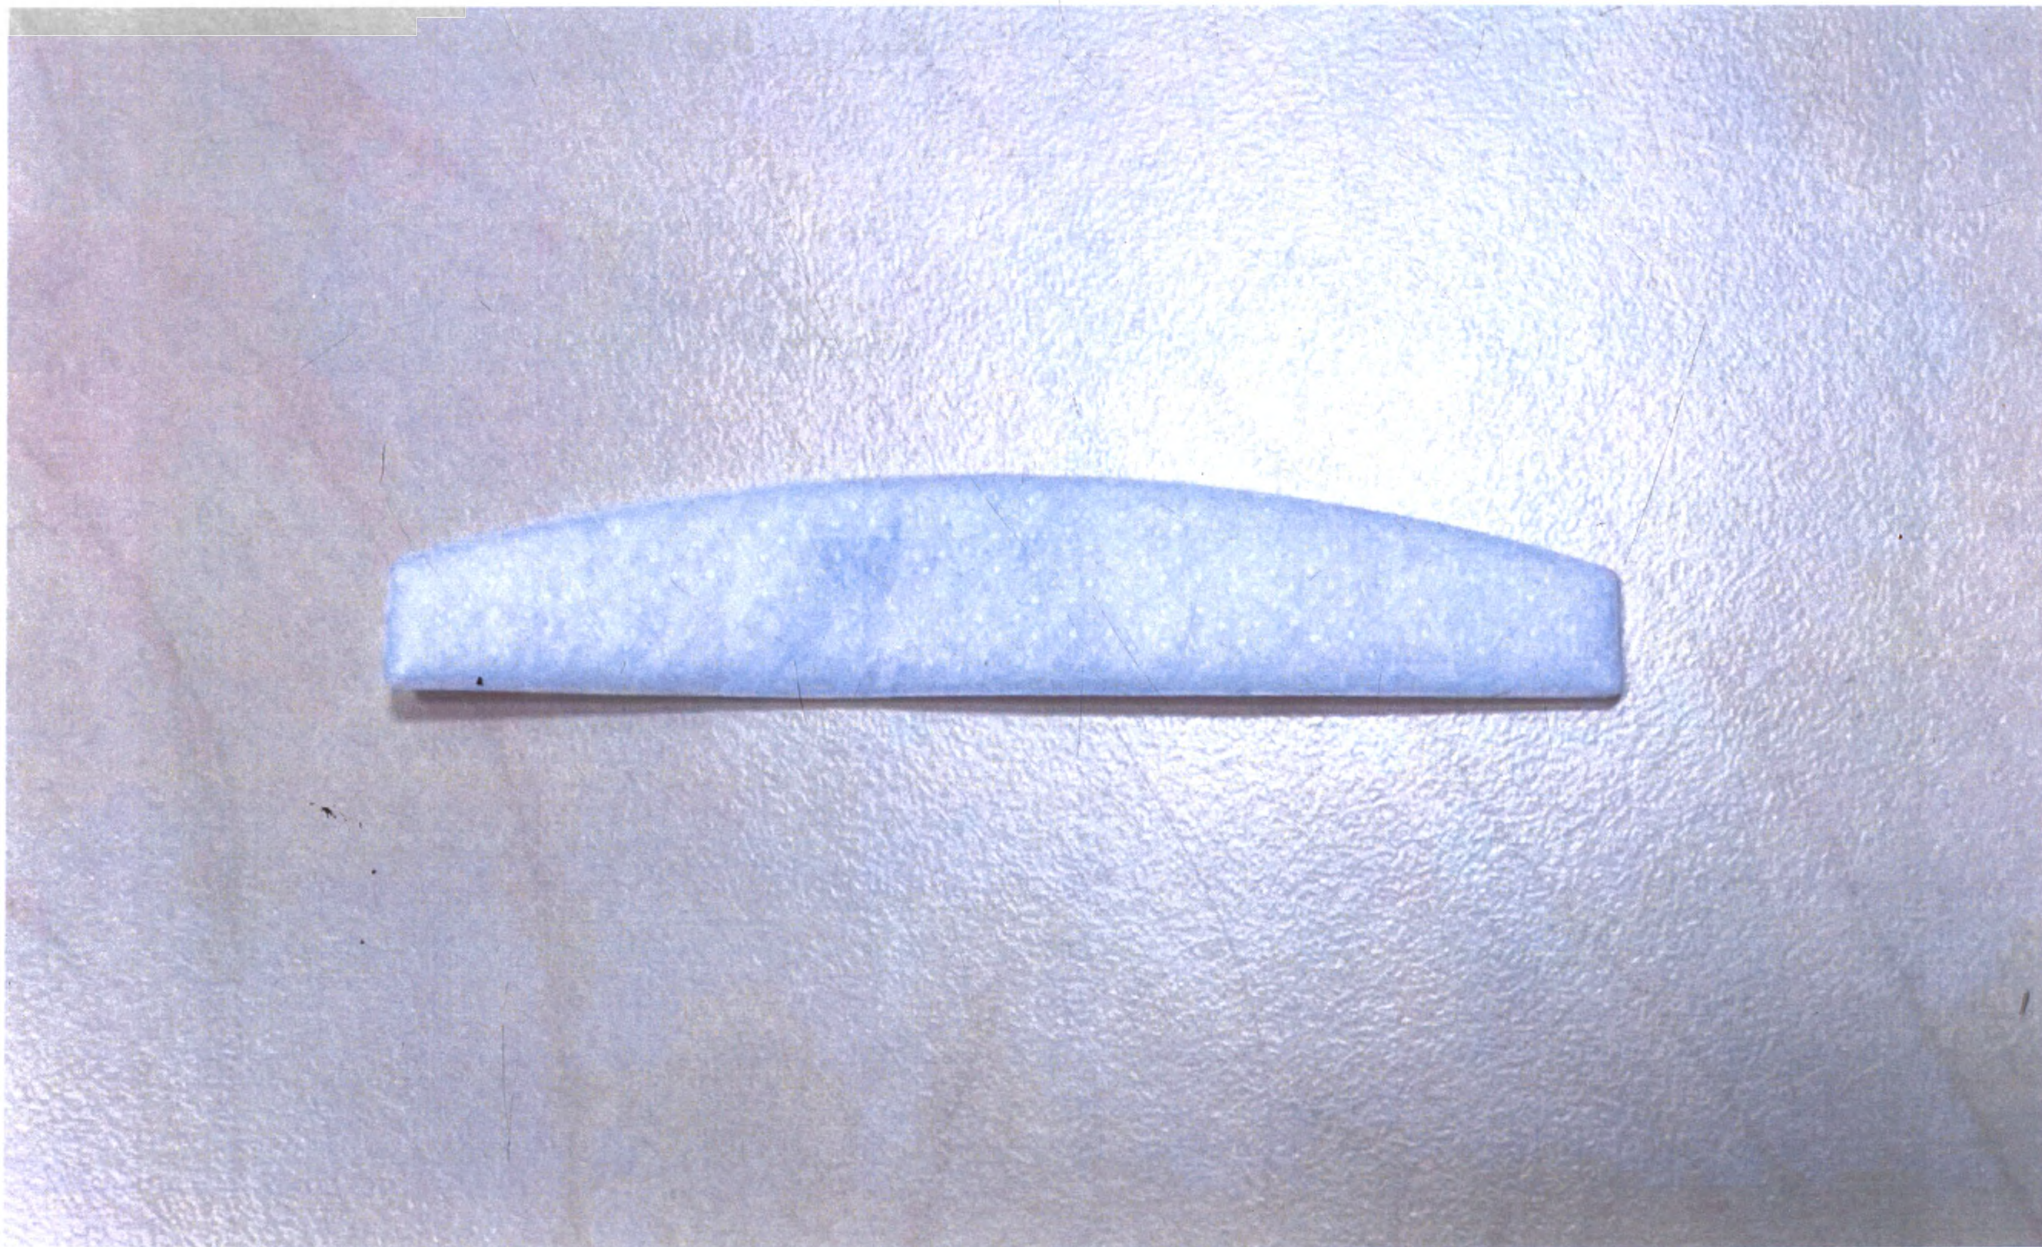


6. Адаптер питания AC/DC.

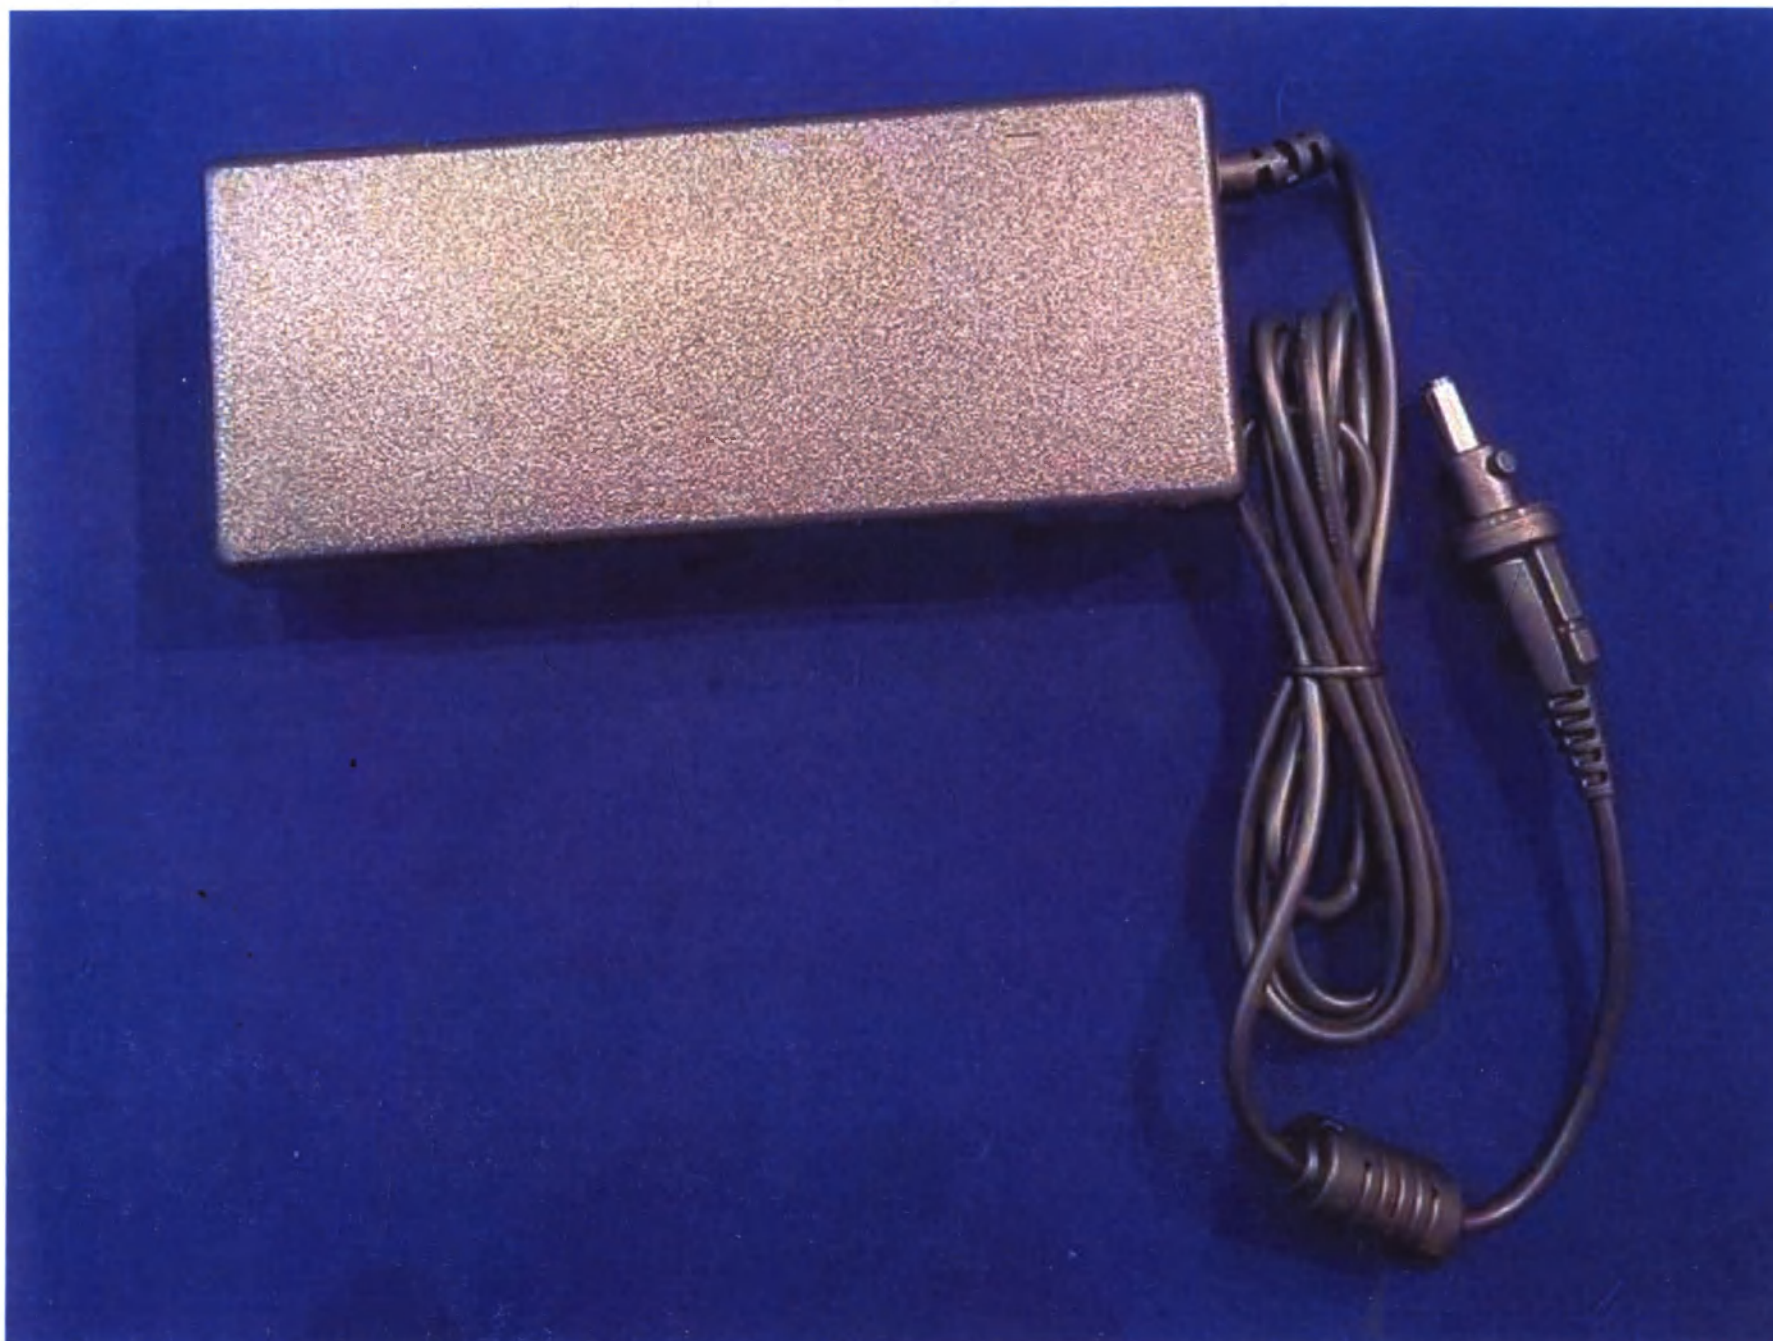

7. Кабель сетевой.

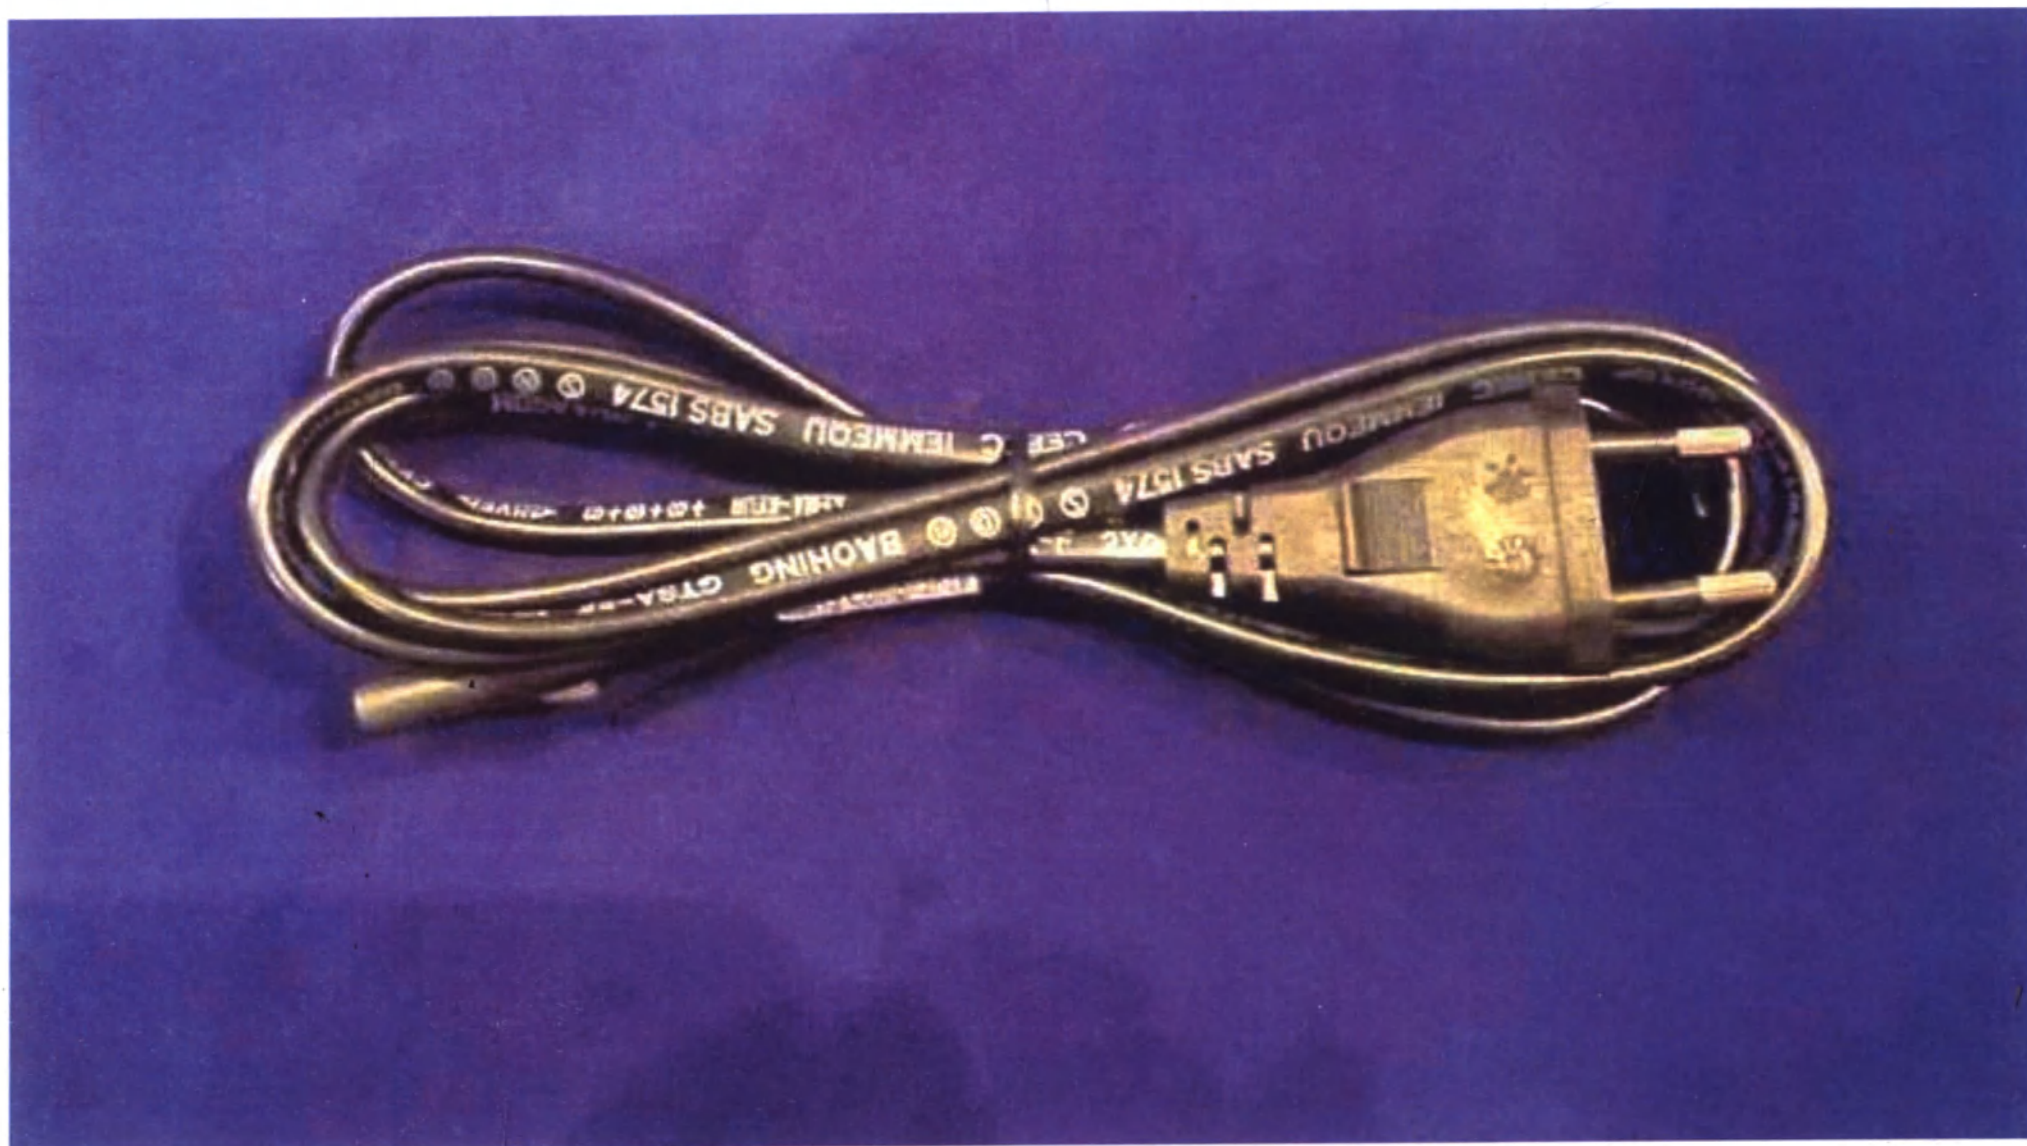


8. Штуцер кислорода низкого давления.

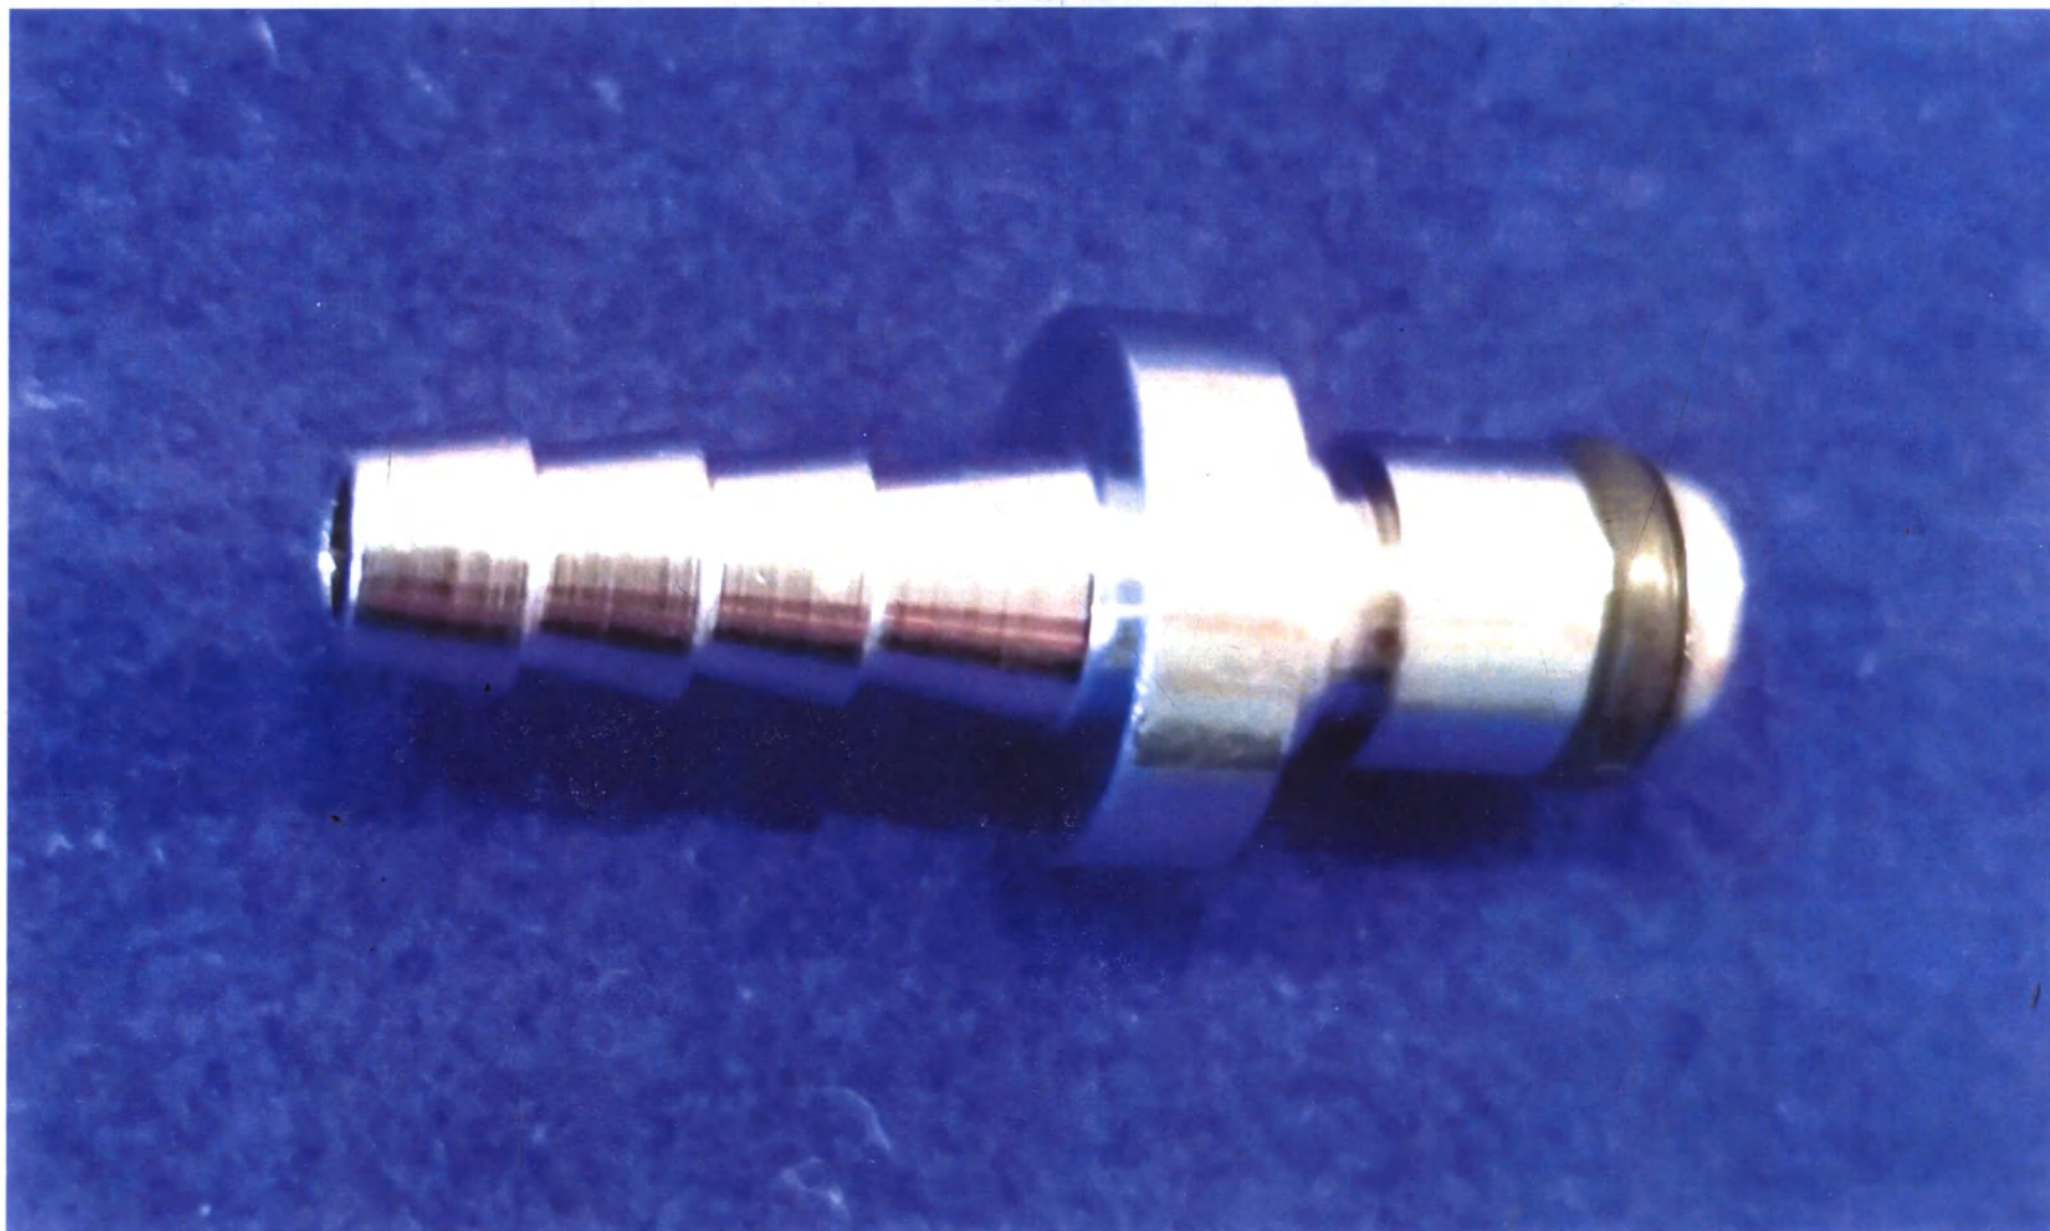





10. Контур пациента односоставной диаметром 15 мм, индивидуальный.

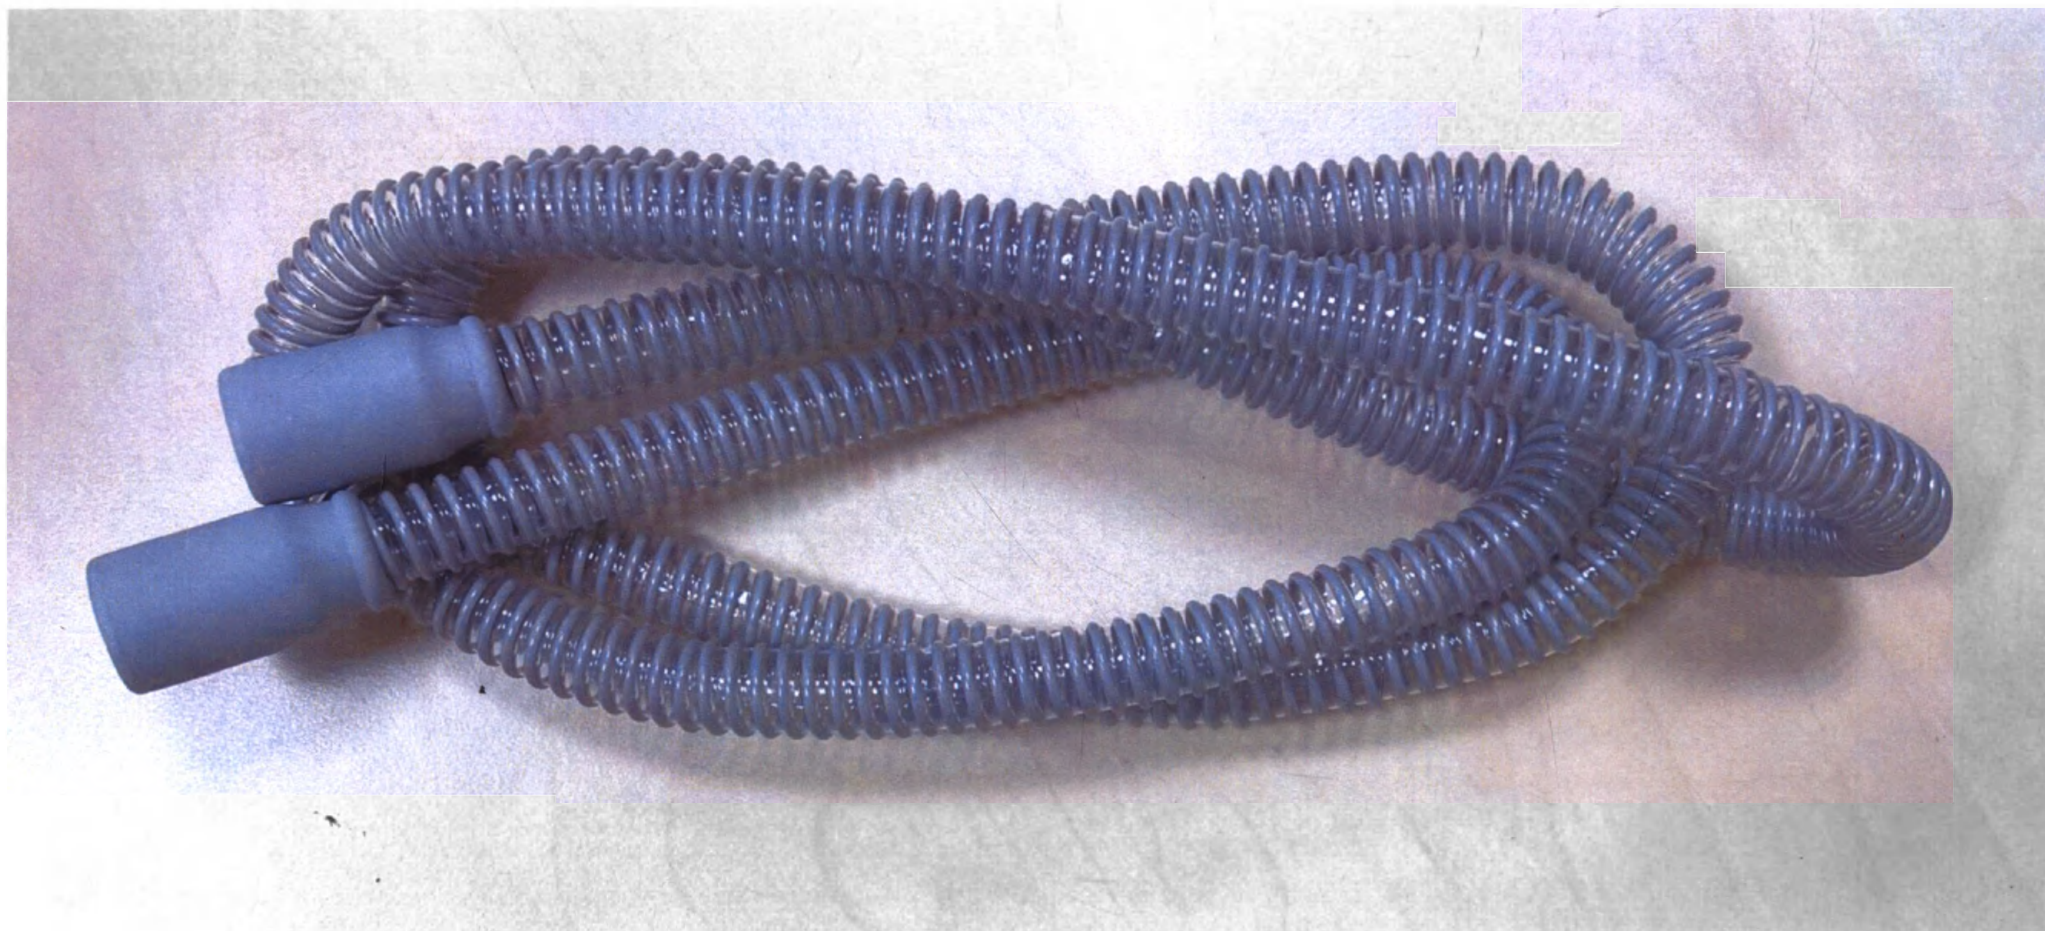


11. Контур пациента односоставной диаметром 22 мм, индивидуальный.

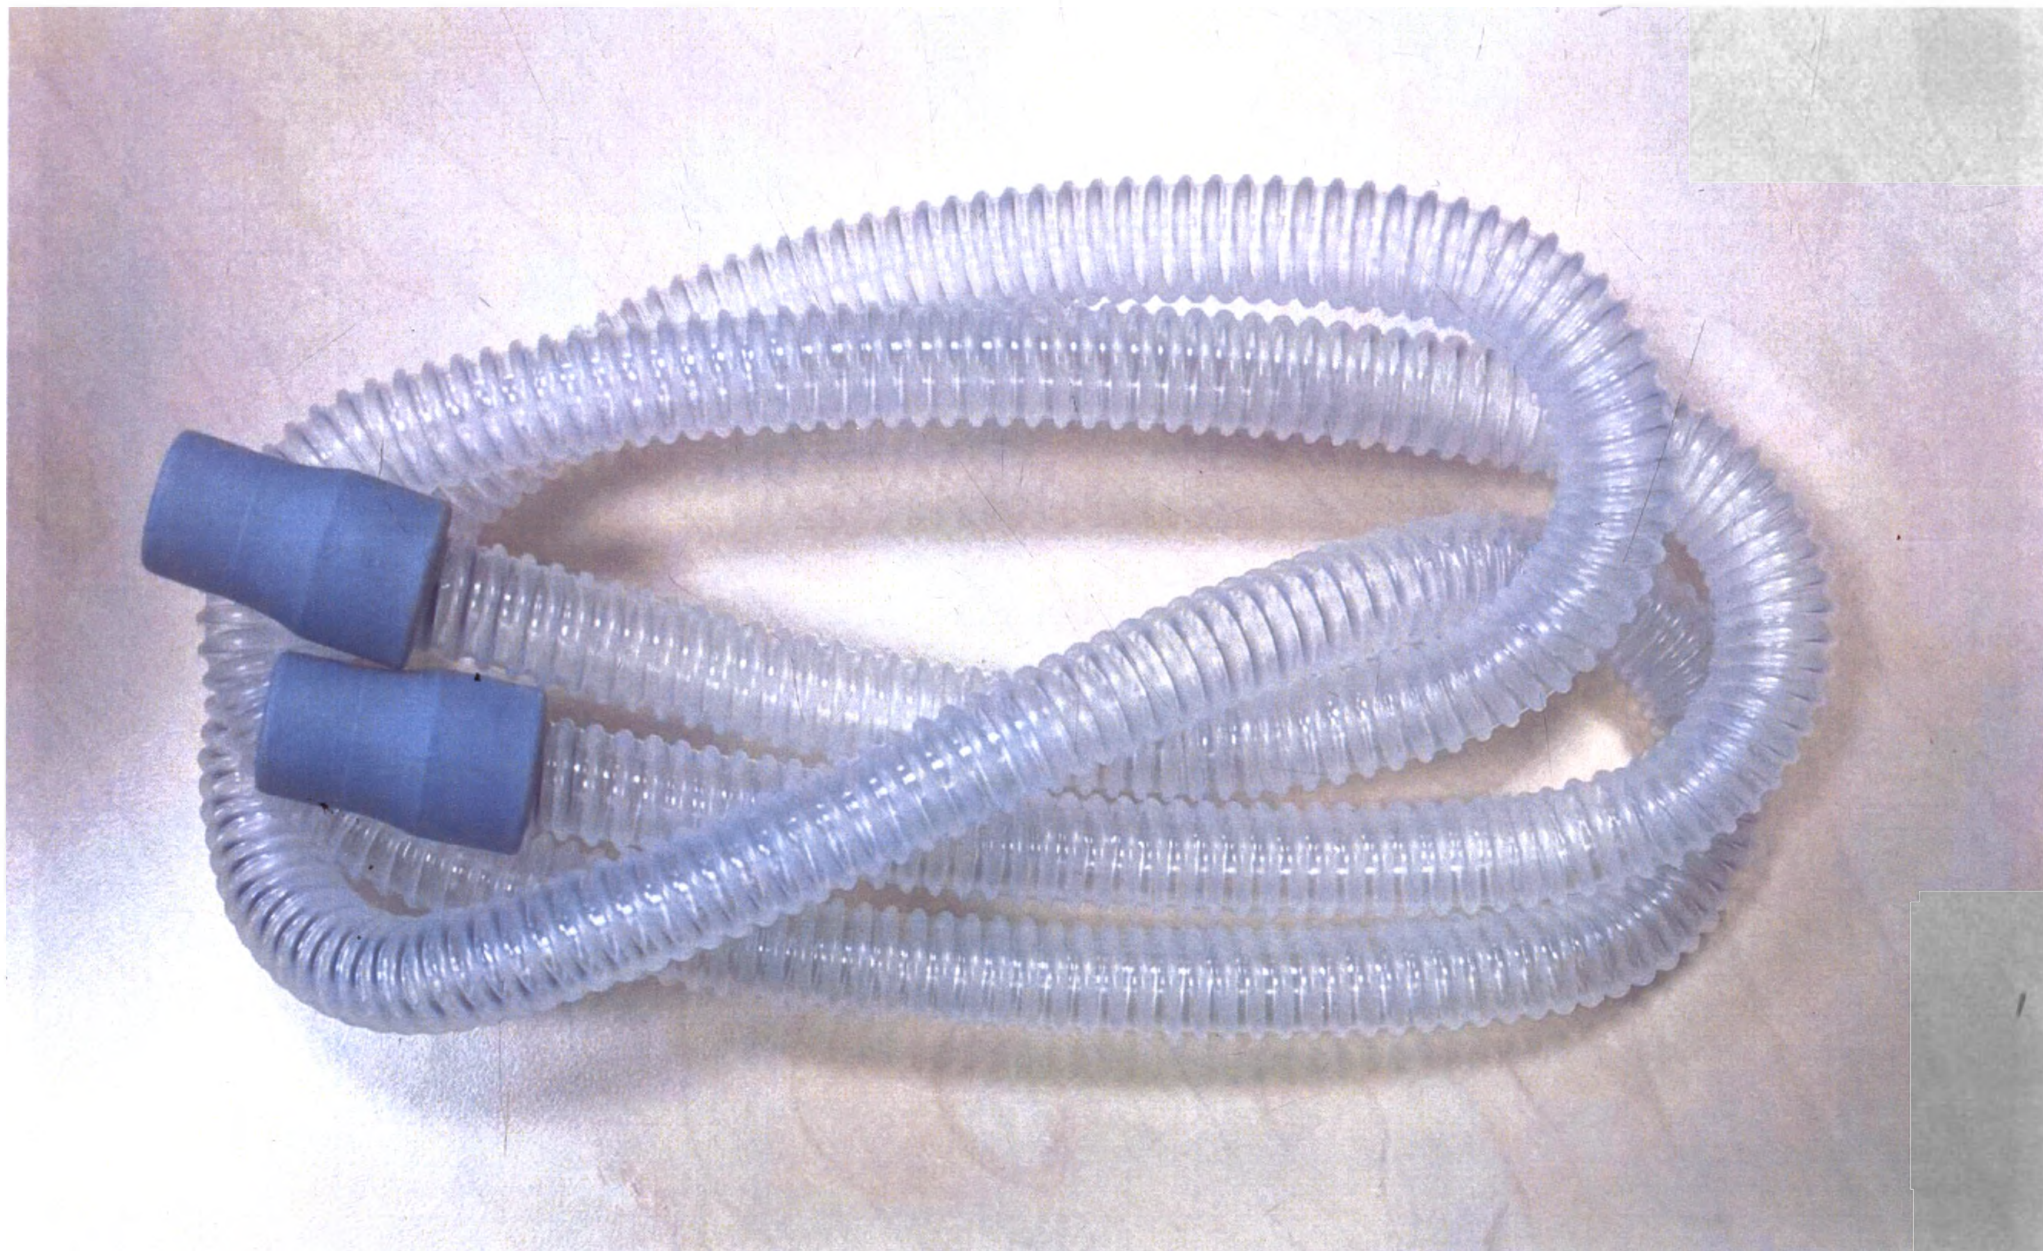


12. Контур пациента односоставной диаметром 15 мм, подогреваемый.

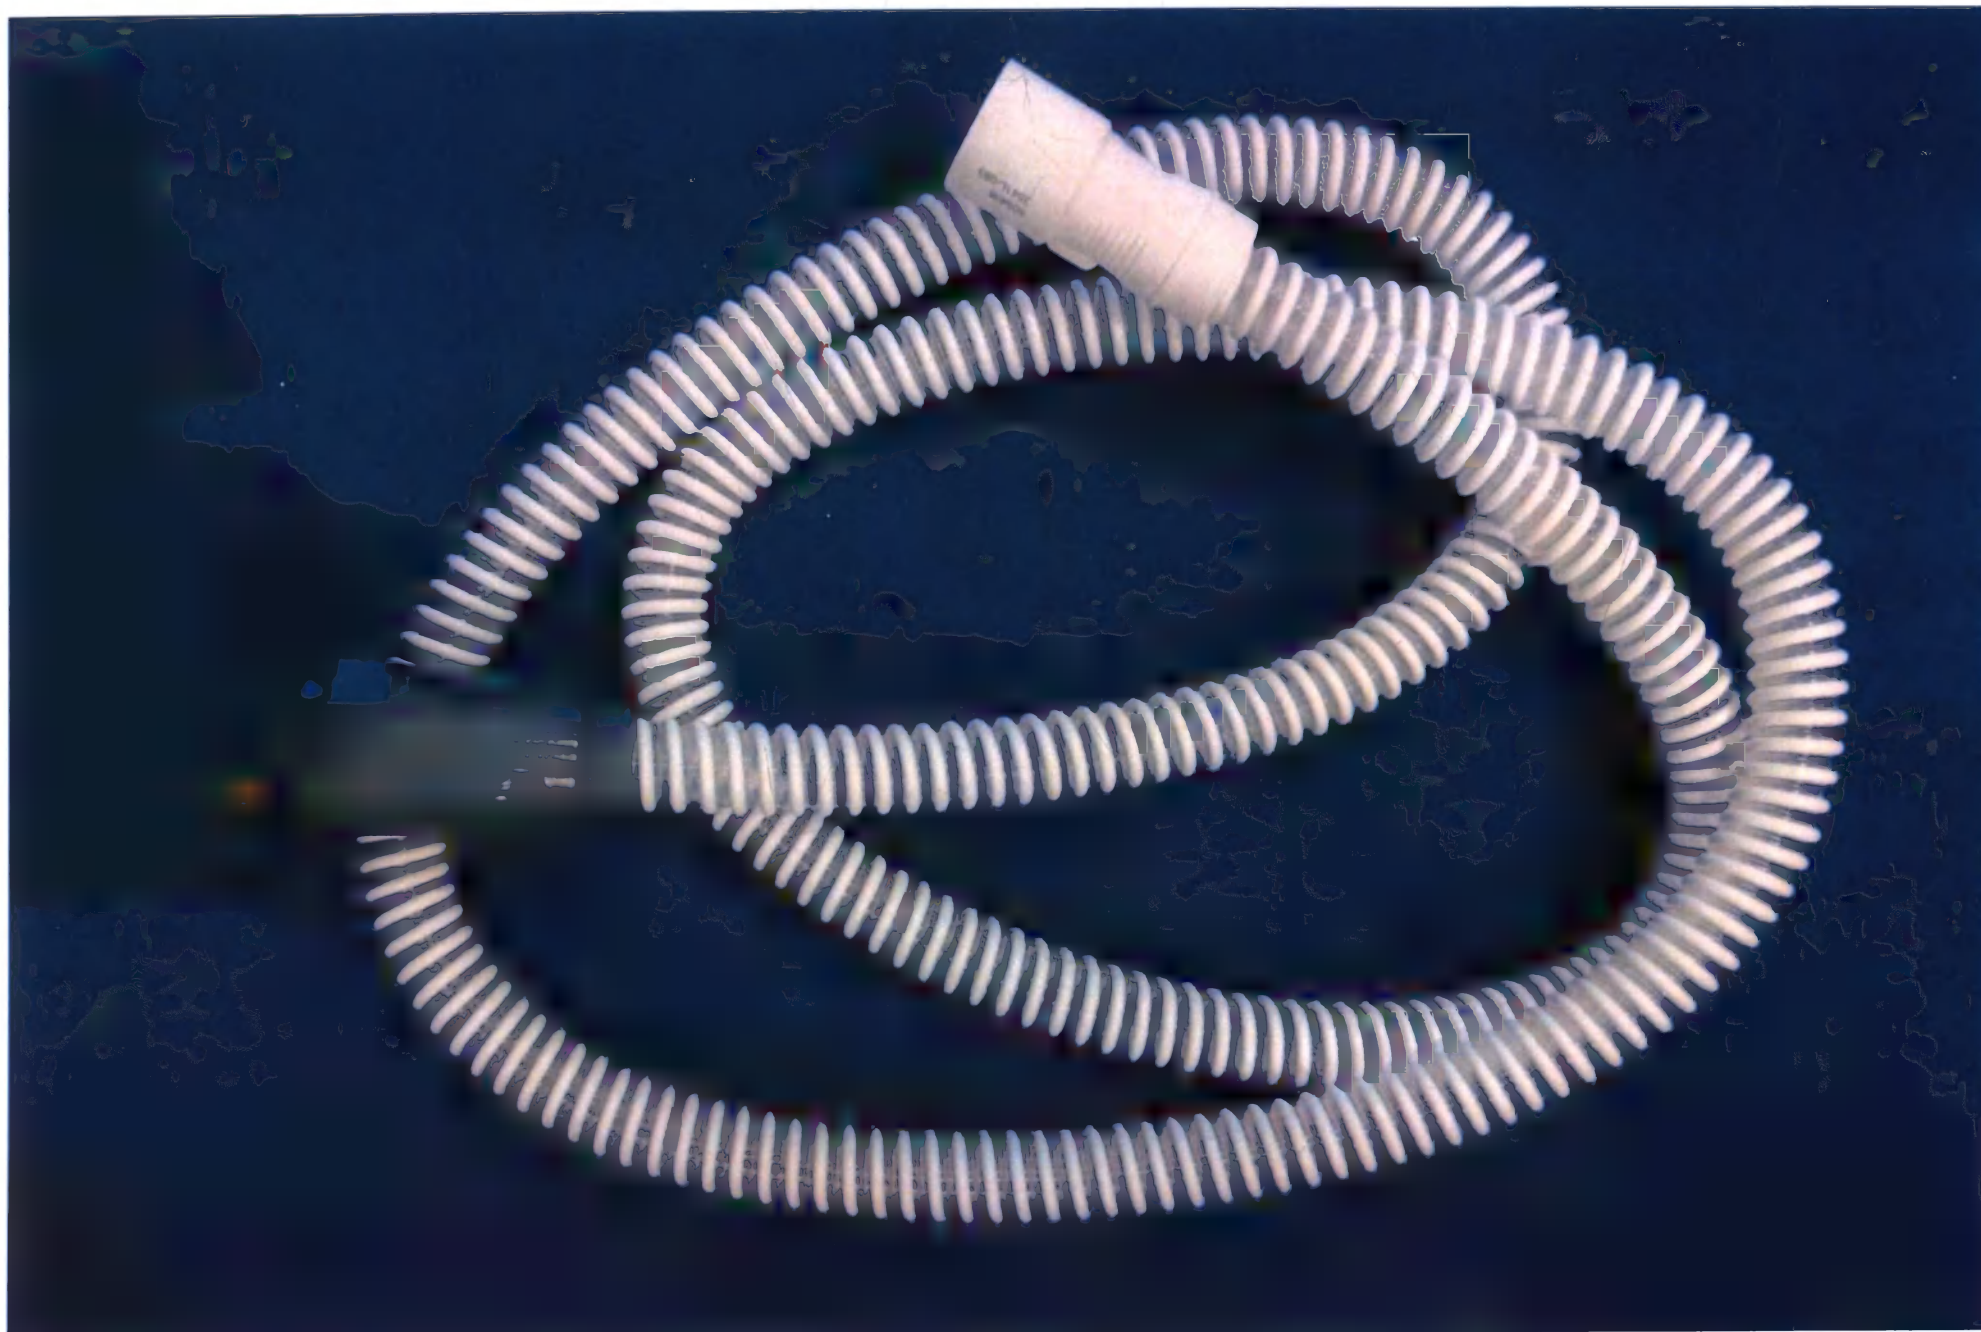

13. Контур пациента односоставной диаметром 22 мм, с фильтром антибактериальным низкого сопротивления, индивидуальный.

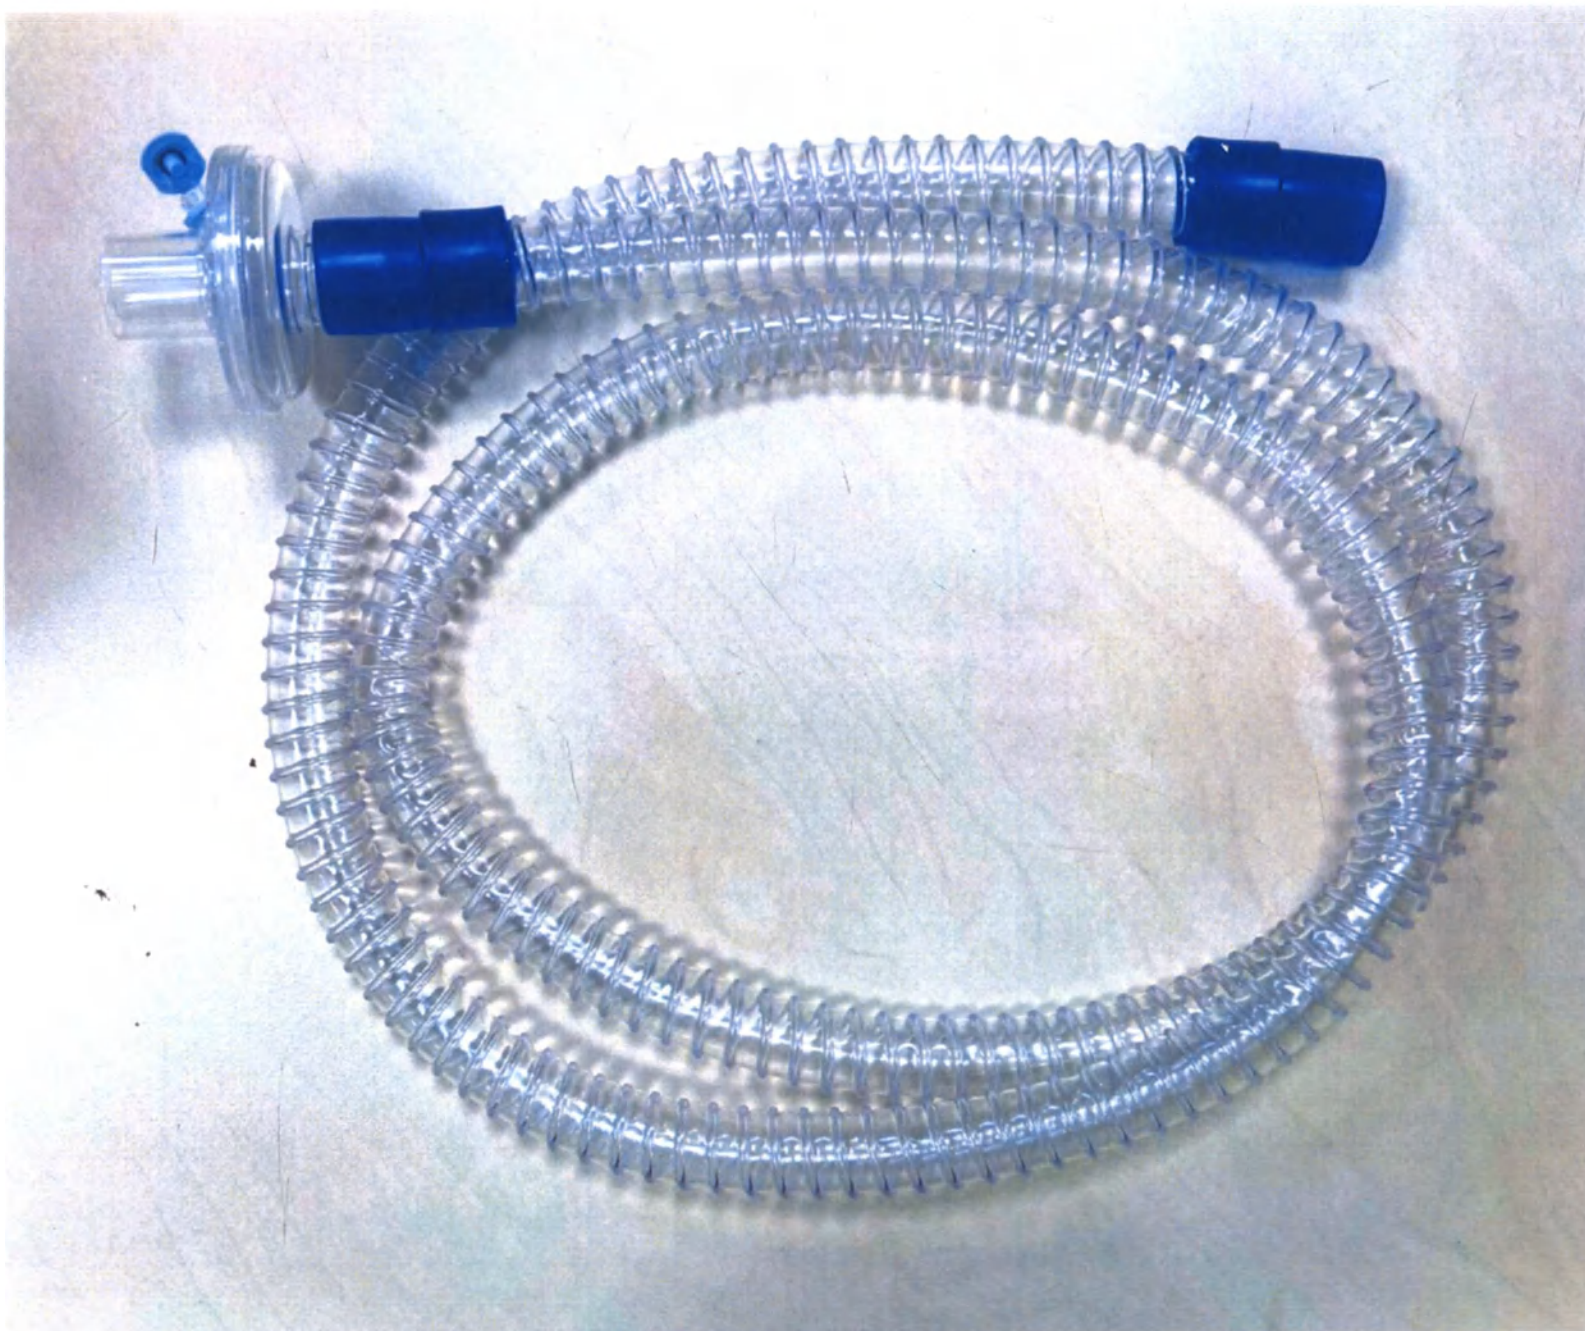


14. Порт утечки.

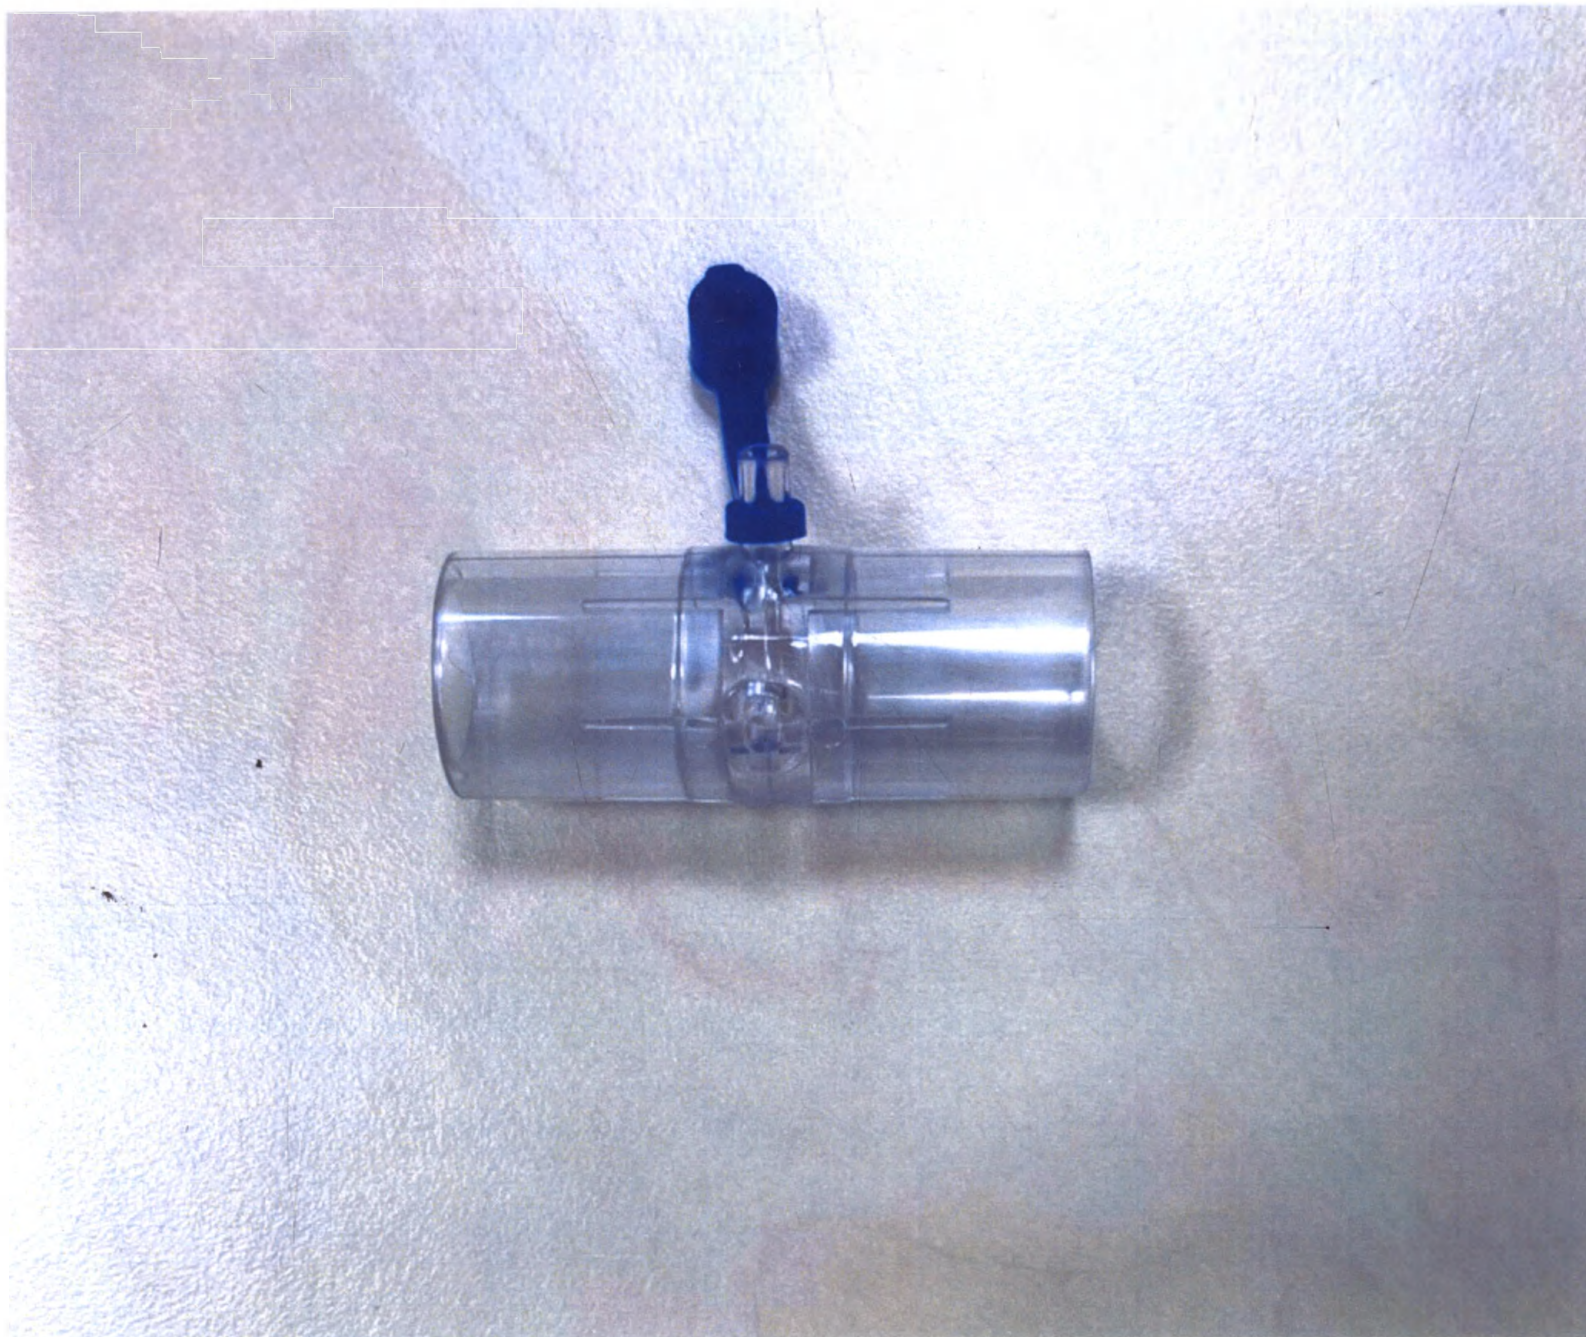




16. Фильтр антибактериальный низкого сопротивления.

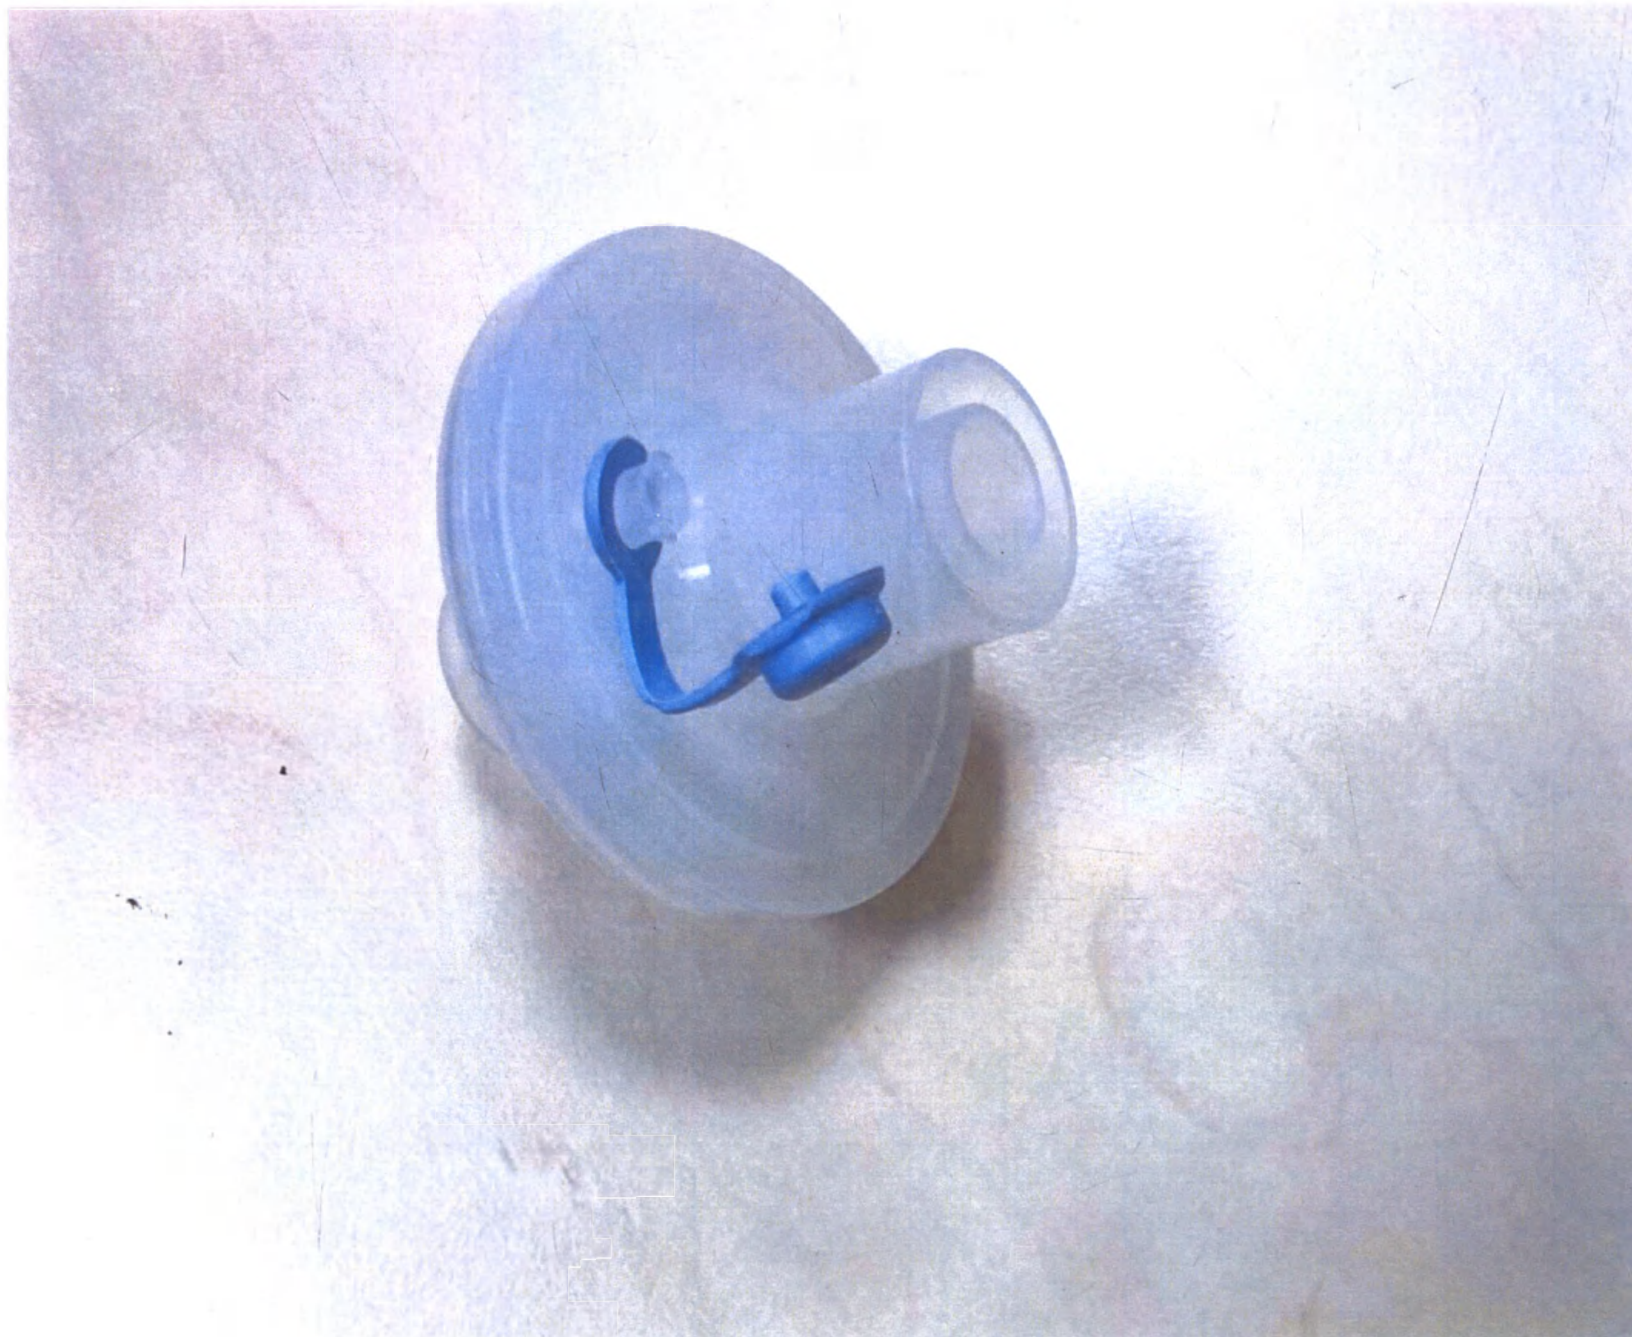




18. Кабель, адаптер внешнего источника постоянного тока.

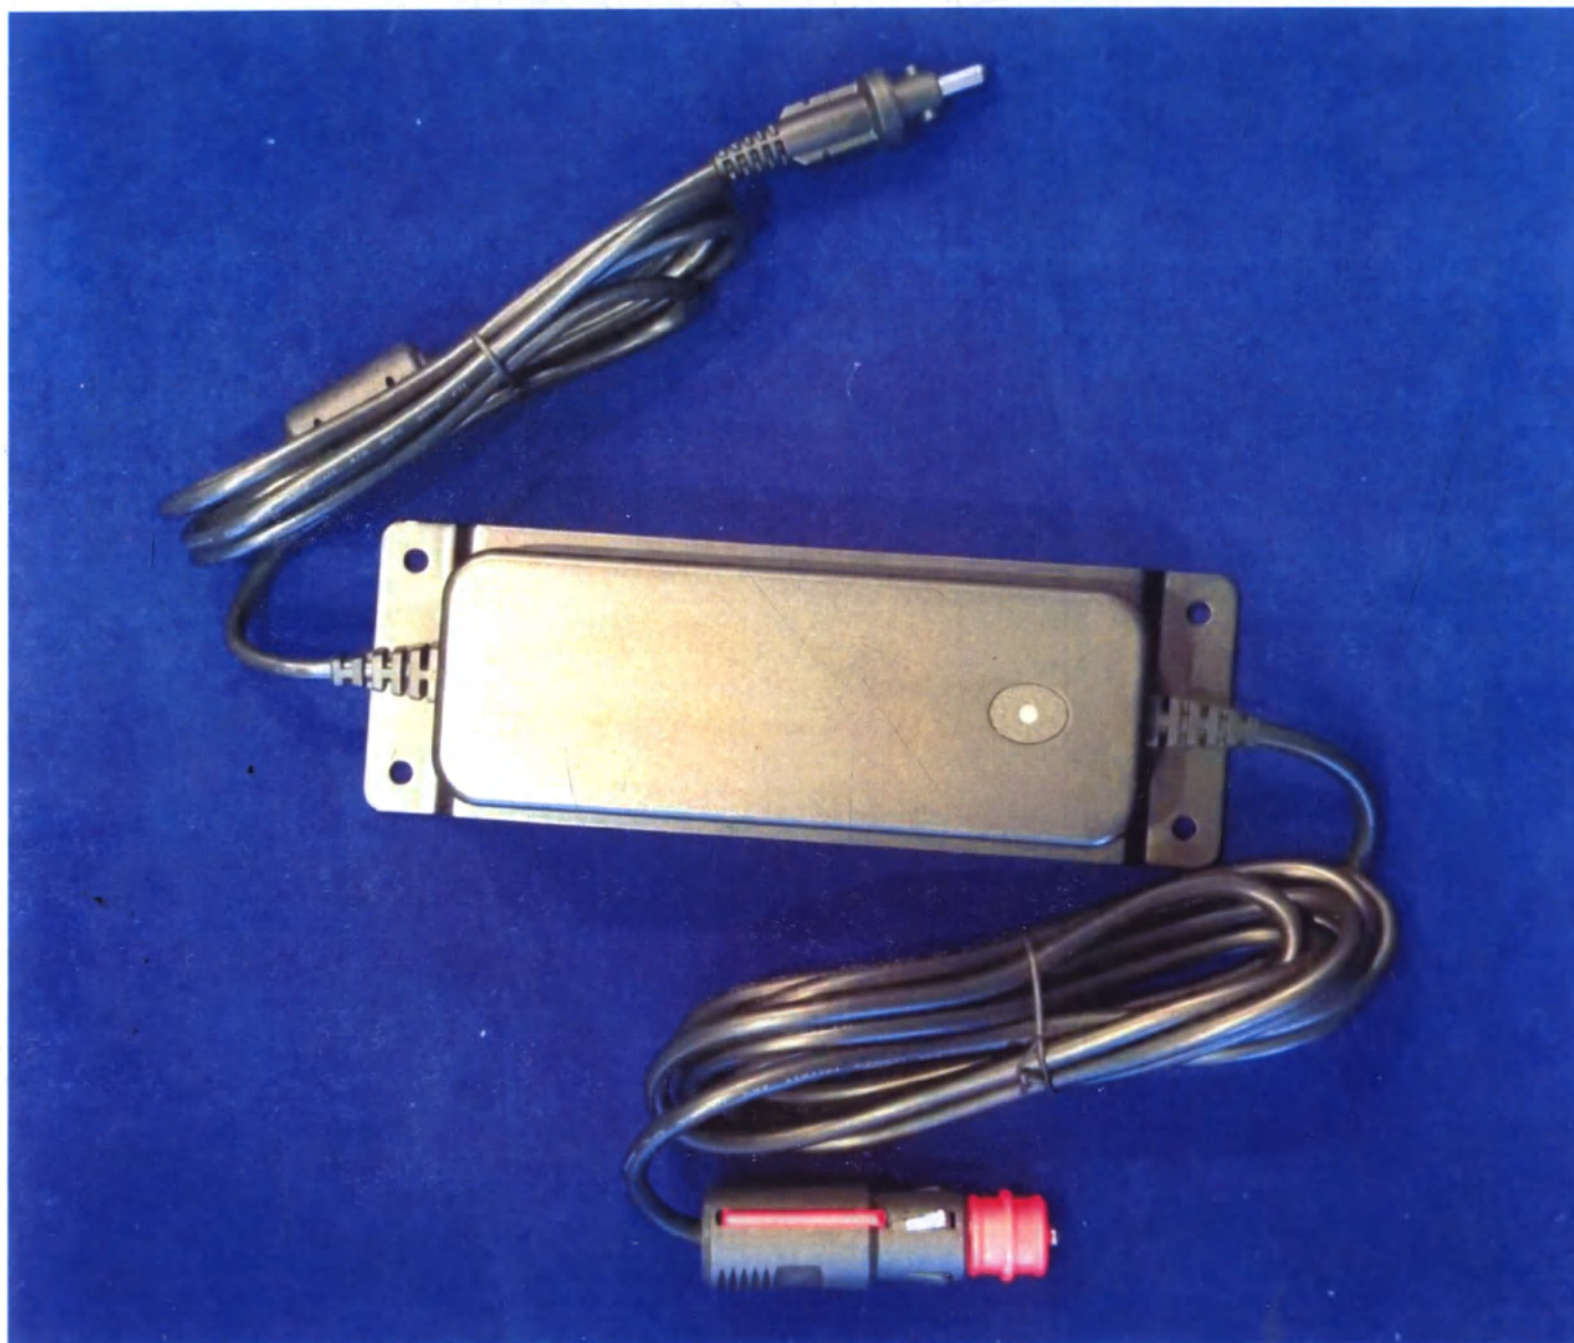


19. Y-кабель для одновременного подключения аппарата к электропитанию переменного и постоянного токов.



20. Кабель для подключения датчика синхронизации по периферическому пульсу.

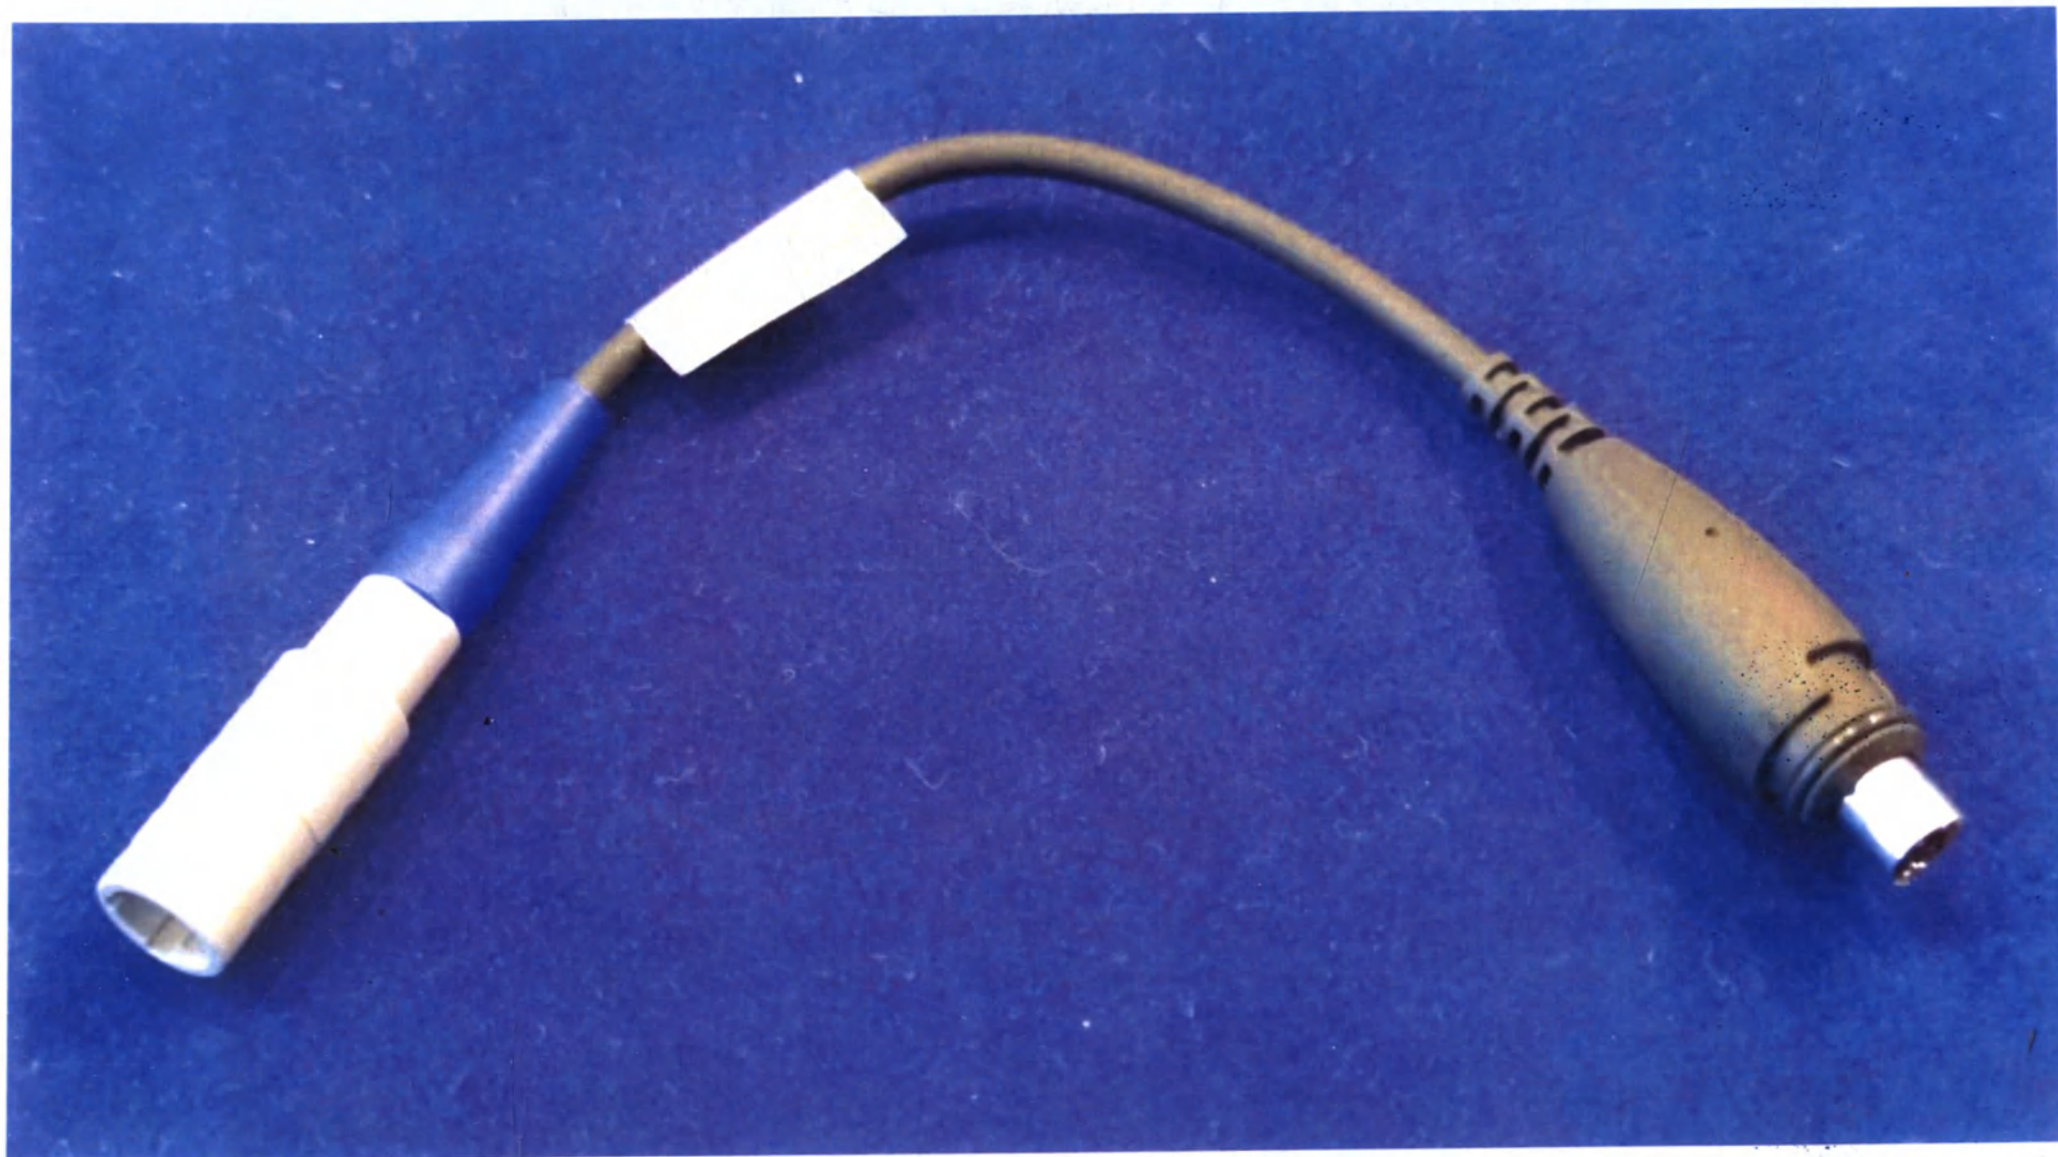

21. Модуль сопряжения SpO2.

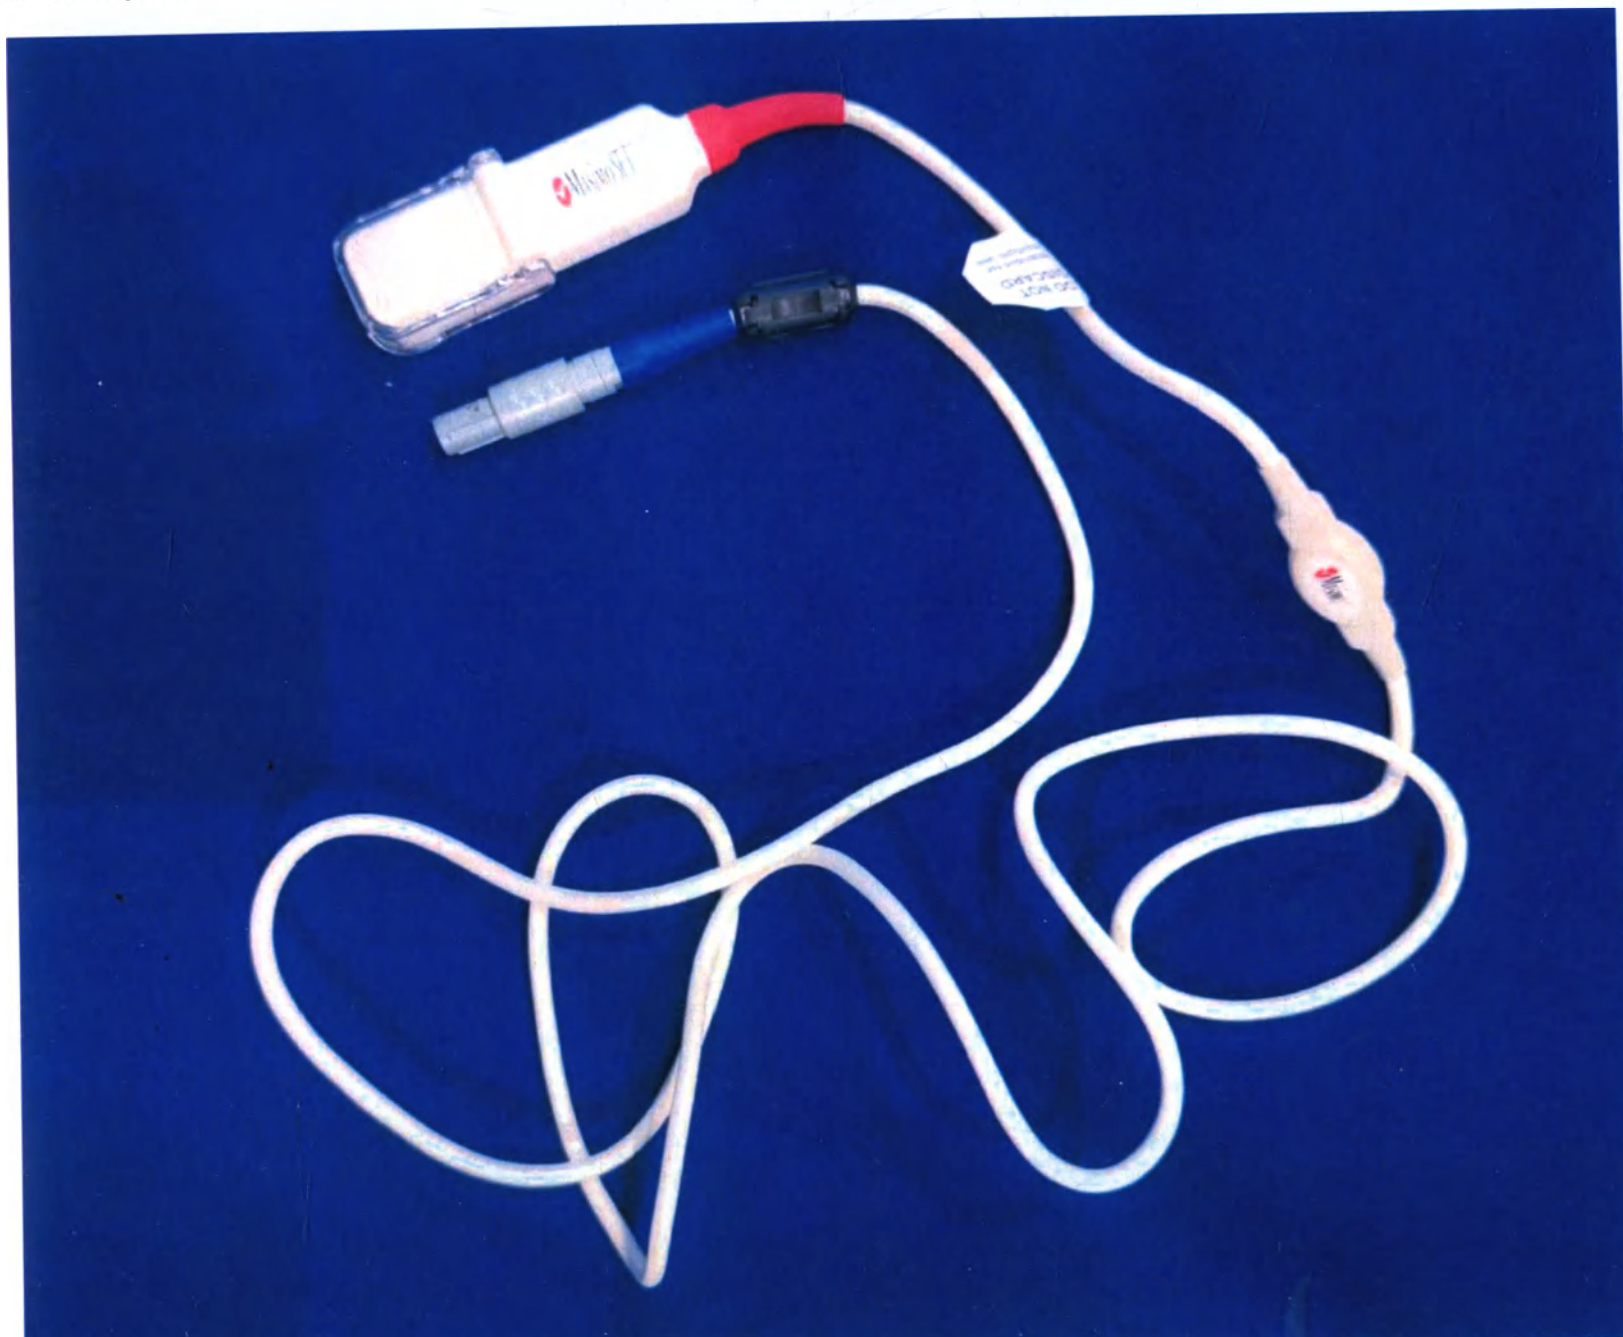

22. Датчик синхронизации по периферическому пульсу, тип клипса, для взрослых.




23. Датчик синхронизации по периферическому пульсу, тип клипса, для детей.






25. Кабель соединительный для батареи аккумуляторной внешней.

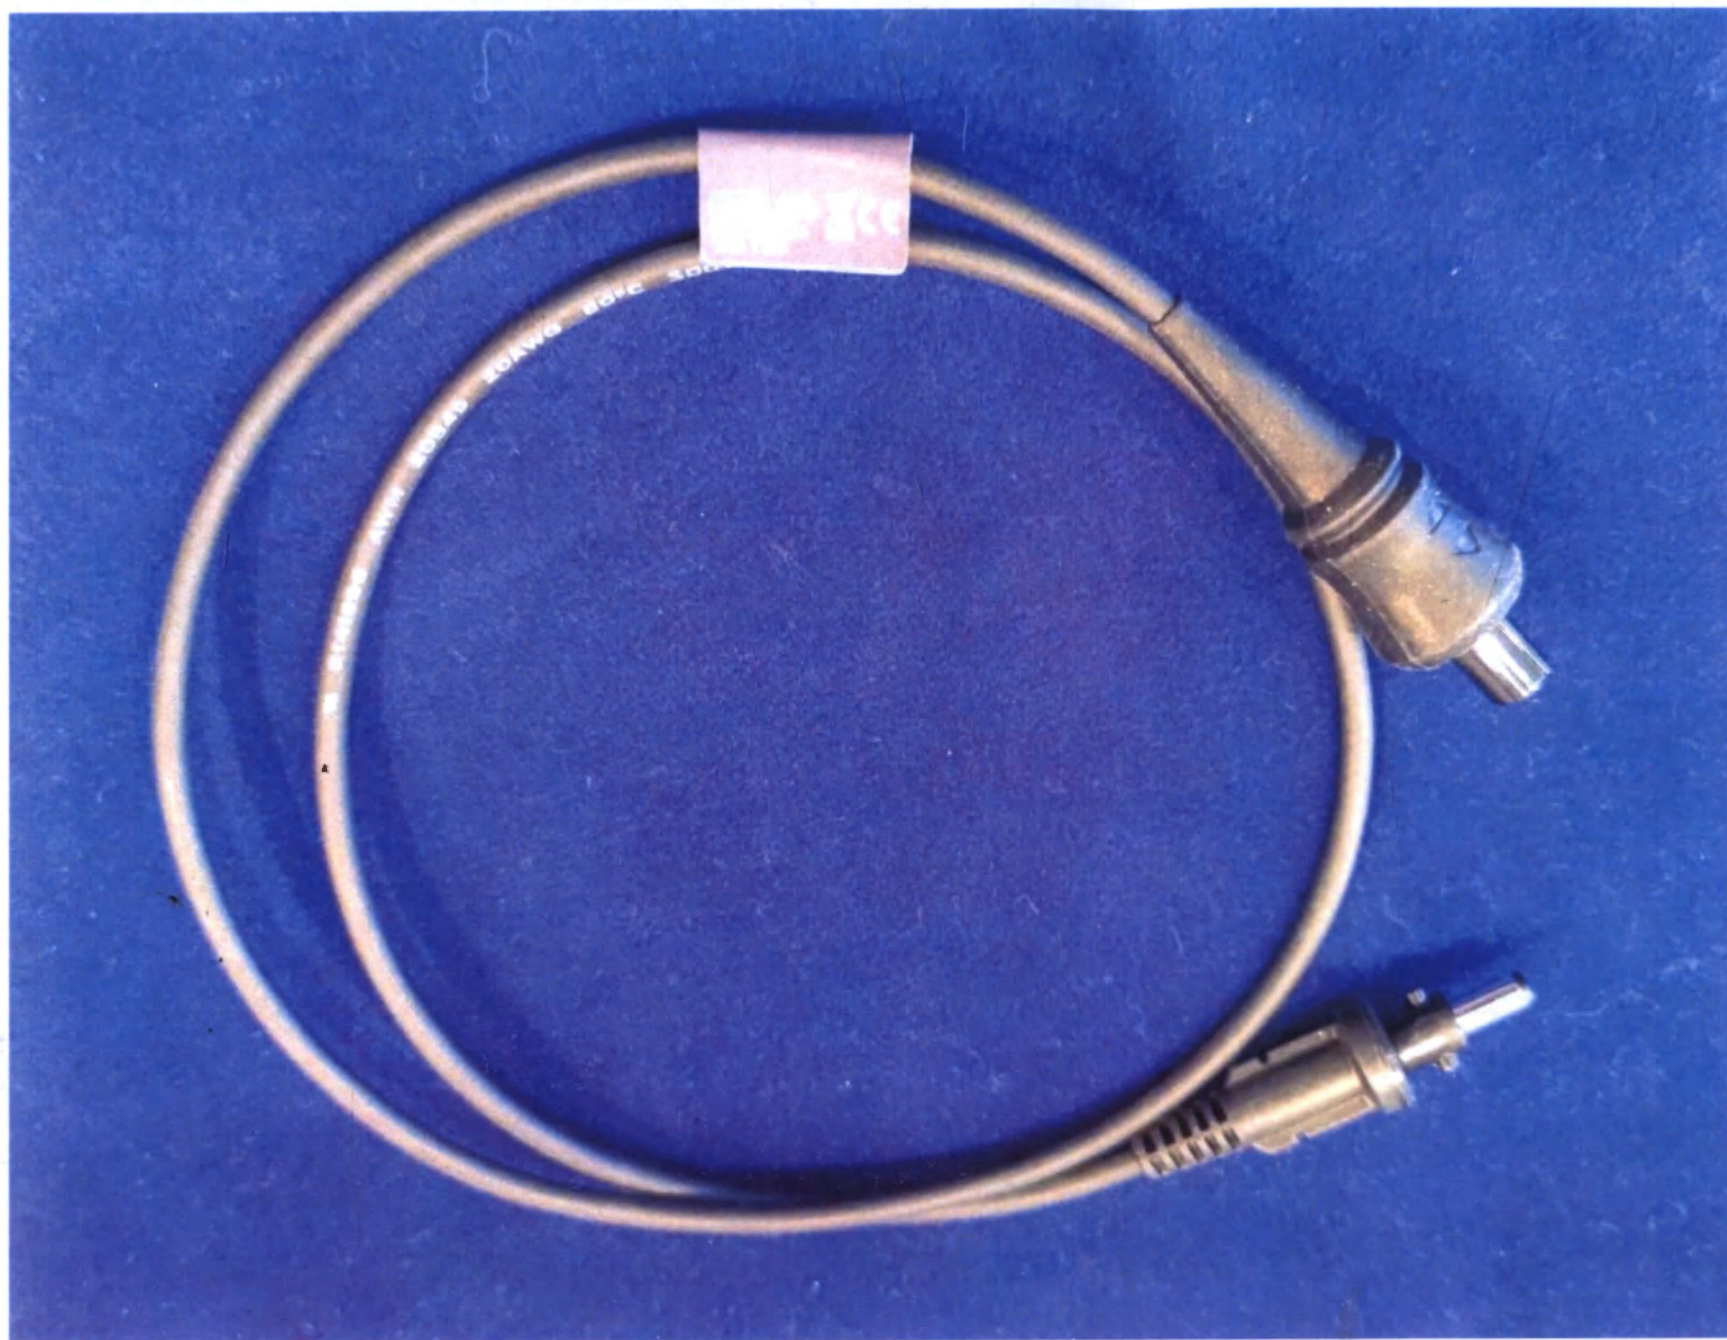






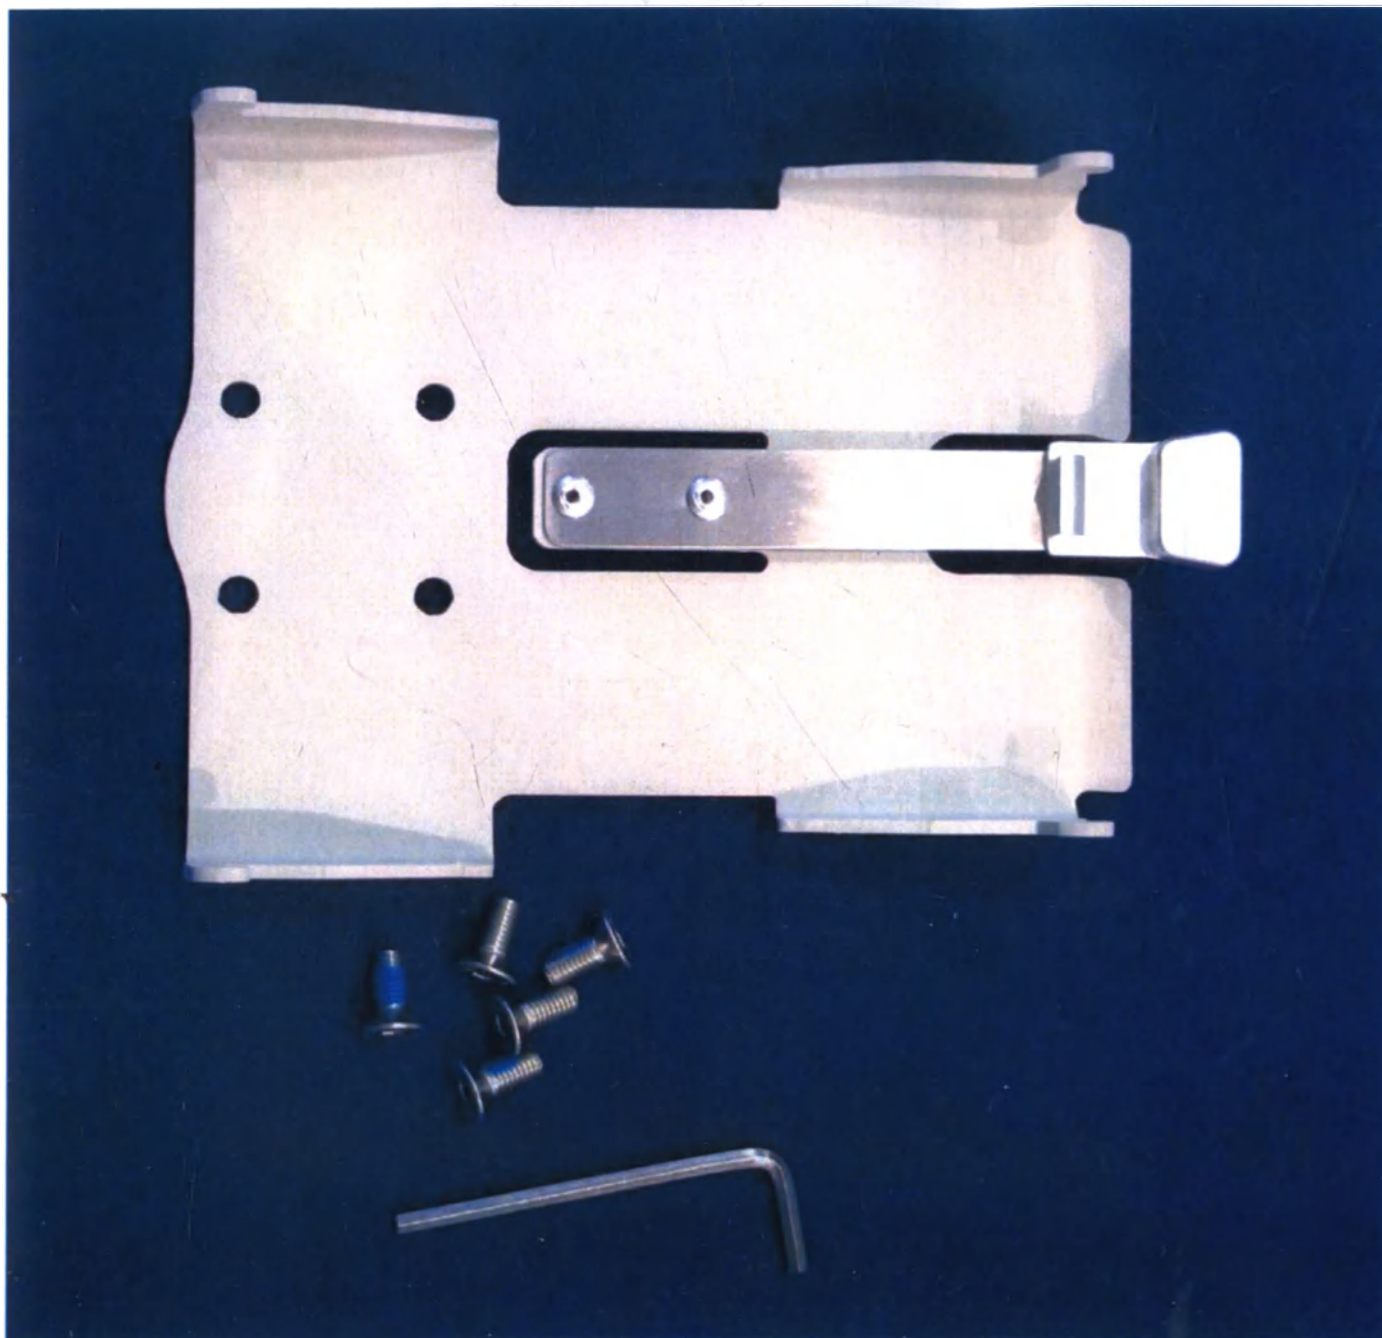


29. Кронштейн контура пациента.



30. Зажим для крепления, универсальный.

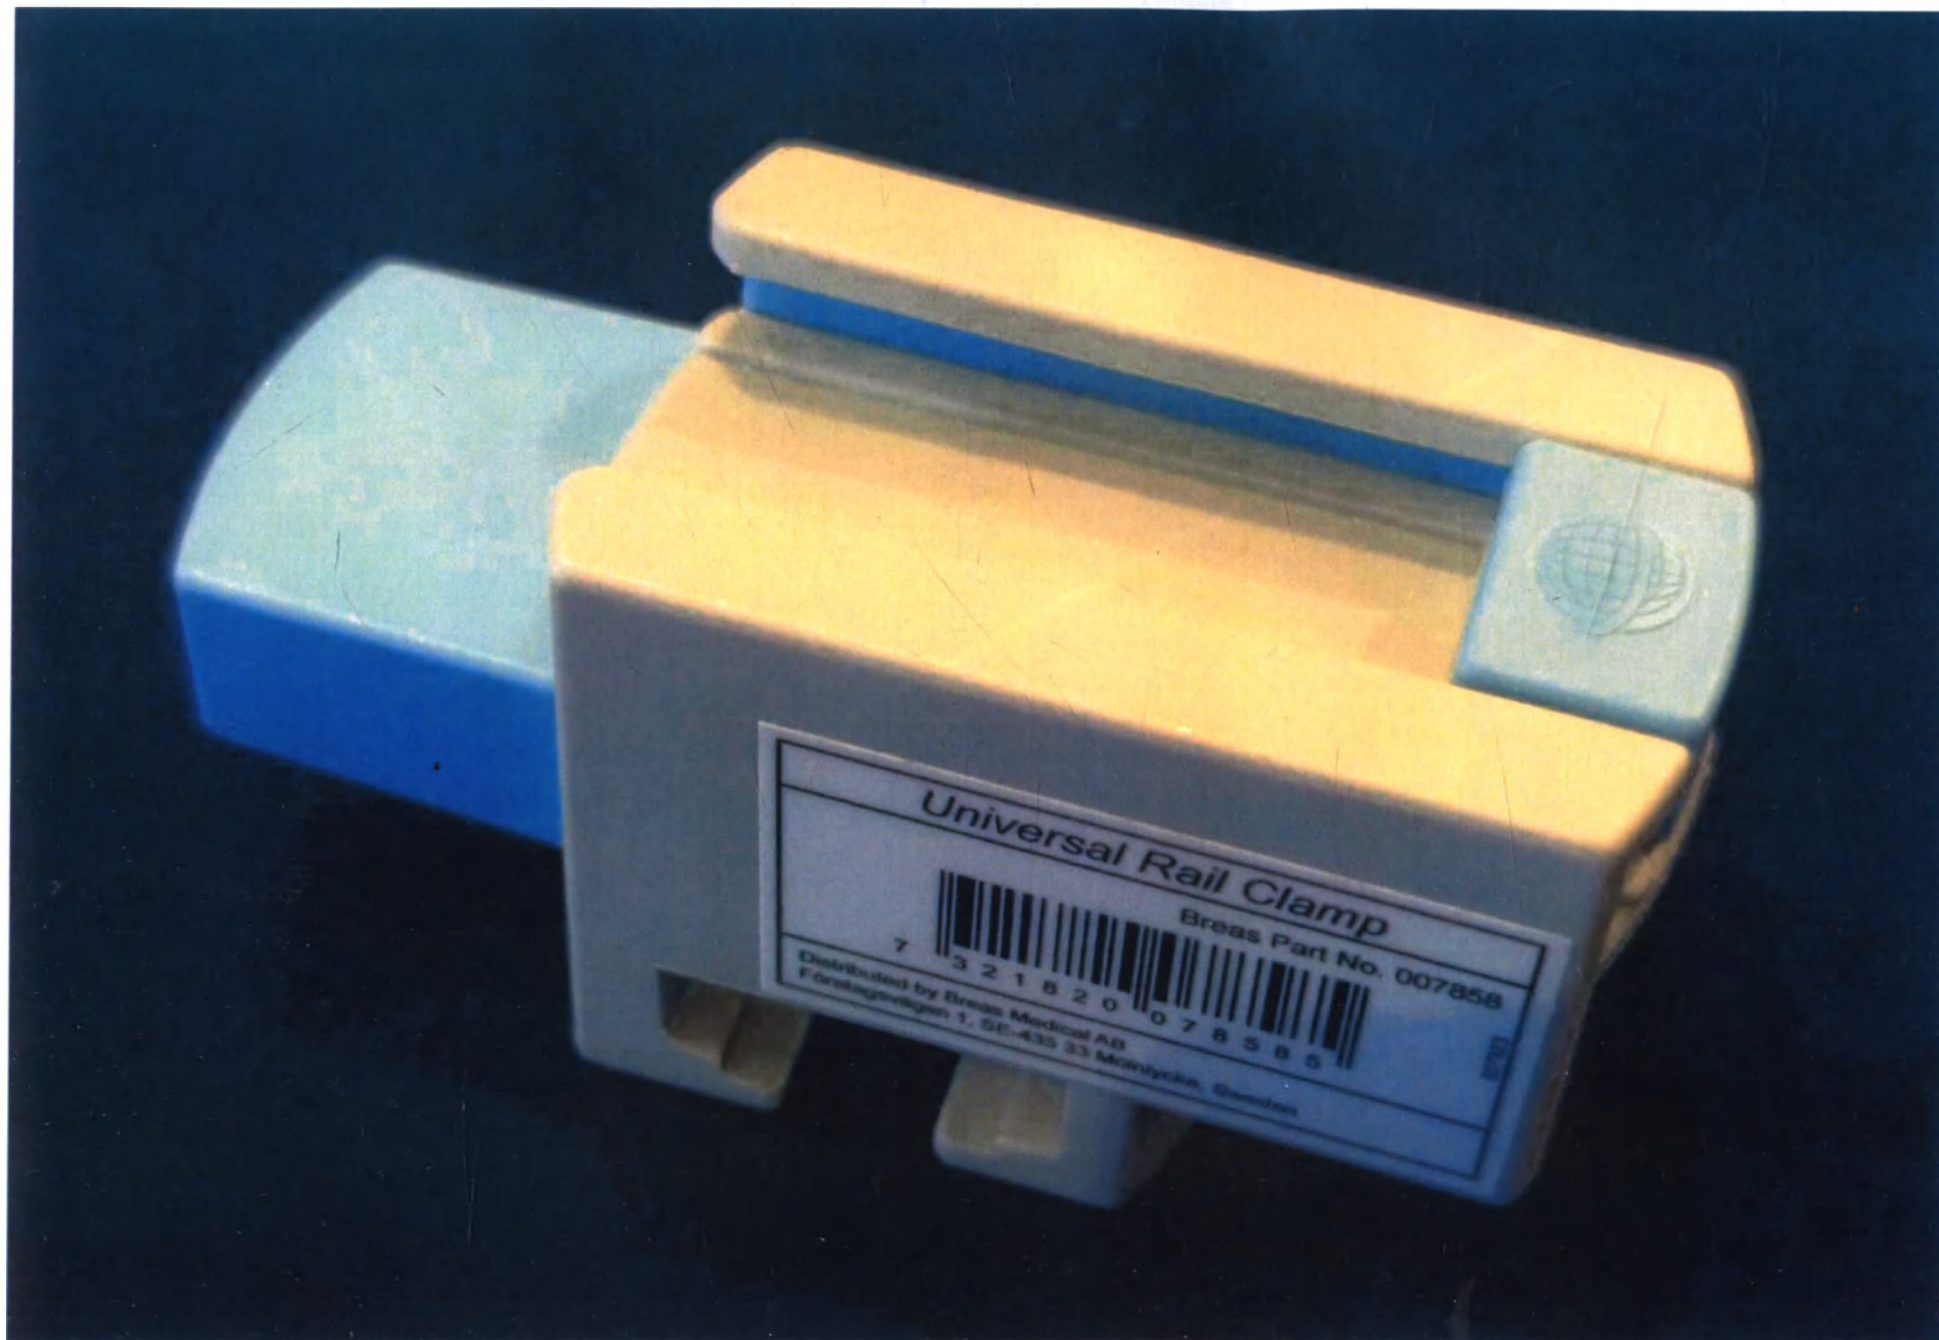

31. Держатель универсальный.

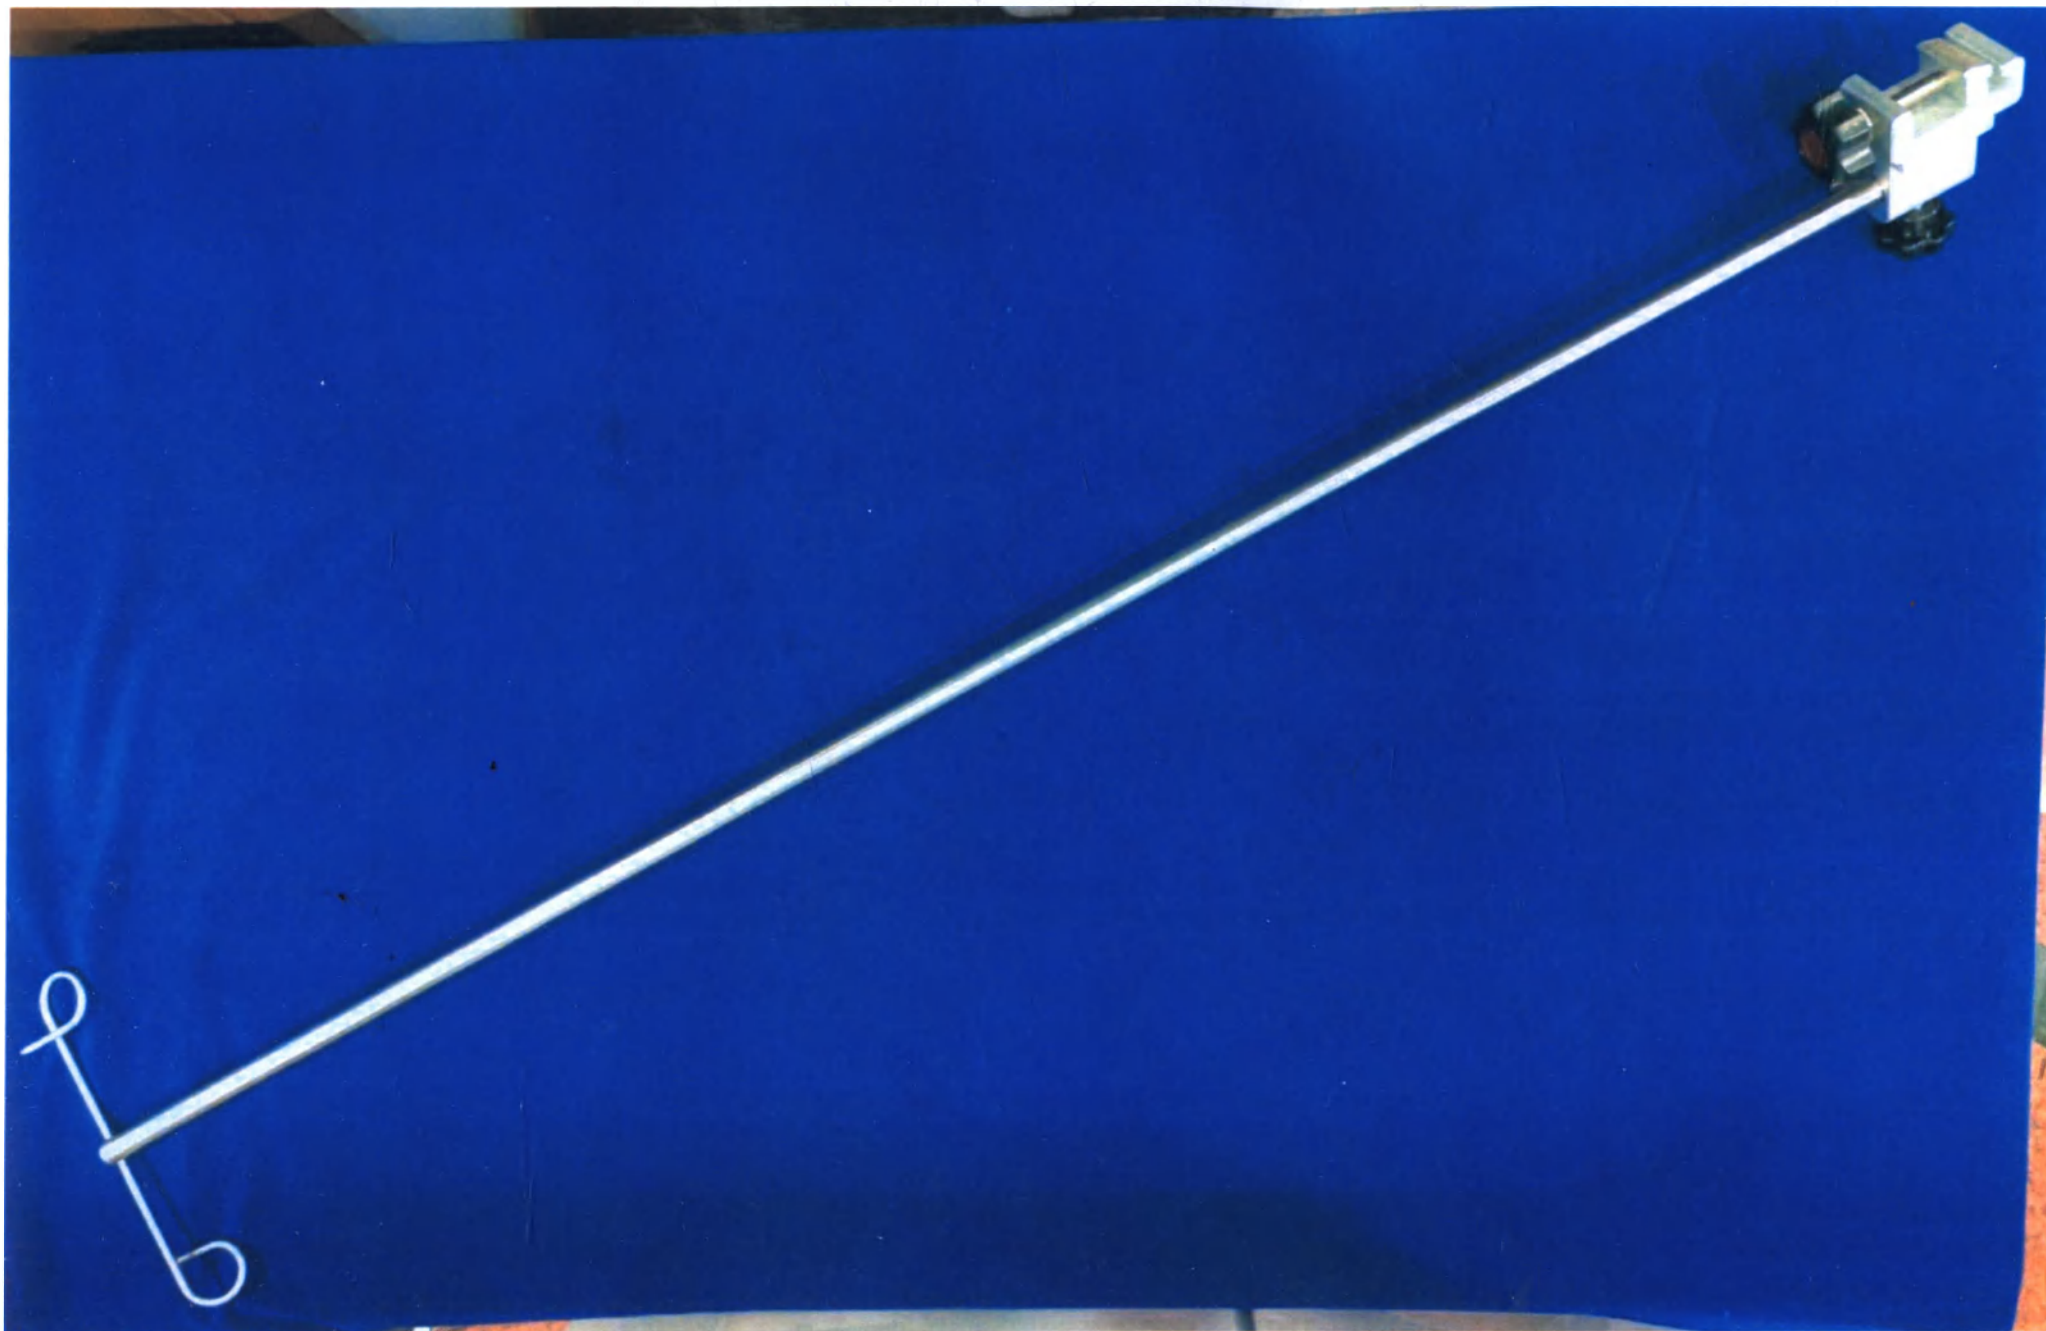



33. Картридж нагревательный для увлажнителя.



34. Сумка транспортная батареи аккумуляторной внешней.





36. Лёгкая транспортная сумка.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
38 (тридцать восемь) листов



Генеральный директор
ООО «С-Инструментс Медикал»

 Д.В.Соколов