

Фотографические изображения

«Реагенты в кассете для количественного определения общего N-терминального пропептида проколлагена I типа P1NP в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys total P1NP cobas e analyzers/TP1NP)»


кассеты в кассете для количественного определения общего N-терминального пропептида проколлагена I типа P1NP в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys total P1NP cobas e analyzers/TP1NP)




...ты в кассете для количественного определения общего N-терминального пропептида проколлагена I типа P1NP
...ротке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys tot.
P1NP cobas e analyzers/TP1NP)



в кассете для количественного определения общего N-терминального пропептида проколлагена I типа P1NP в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys total P1NP cobas e analyzers/TP1NP)

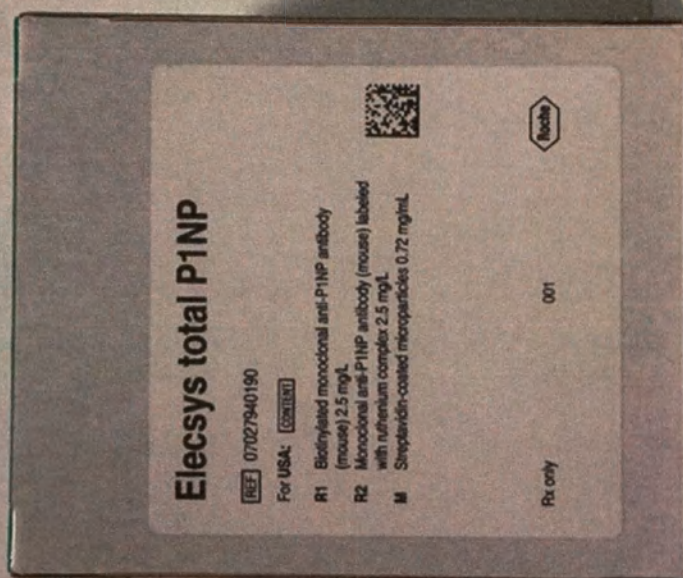

в кассете для количественного определения общего N-терминального проколлагена I типа P1NP в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys total P1NP cobas e analyzers/TP1NP)

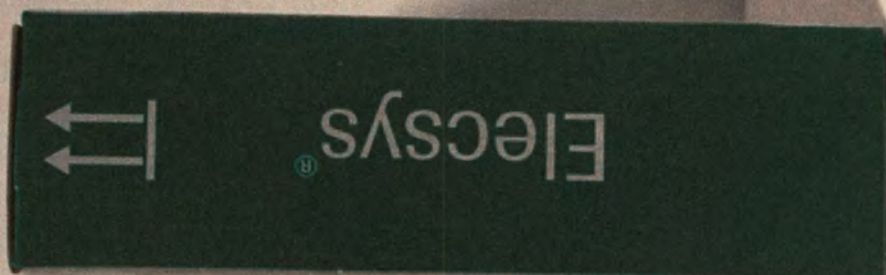

в кассете для количественного определения общего N-терминального пропептида проколлагена I типа PINP в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys total PINP cobas e analyzers/TPINP)

Реагенты в кассете для количественного определения общего N-терминального пропептида проколлагена I типа PINP в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys total PINP cobas e analyzers/TPINP)
Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer
Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики *In vitro*

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной
ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031,
Москва, Трубиня площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail:
moscow.registration_dia@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе
предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному
представителю на территории РФ, контакты см. выше)

Кат. номер 07027940190

в кассете для количественного определения общего N-терминального пропептида проколлагена I типа P1NP
в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys tot.
cobas e analyzers/TP1NP)




в кассете для количественного определения общего N-терминального пропептида проколлагена I типа P1NP в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys total P1NP cobas e analyzers/TP1NP)



в кассете для количественного определения общего N-терминального пропептида проколлагена I типа P1NP
в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys tot
P cobas e analyzers/TP1NP)



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
9 листа (ов)

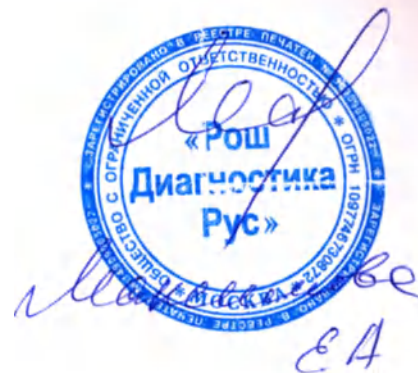

по доверенности
от 30.01.2023 г.