

Директор по качеству и регистрации

ООО «Сименс Здравоохранение»

А.В. Фирстова

«29» ноября 2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система ультразвуковая диагностическая ACUSON Redwood

с принадлежностями»


Базовый состав:



1.1 Система ультразвуковая диагностическая ACUSON Redwood.




1.2 Система ультразвуковая диагностическая ACUSON Redwood.

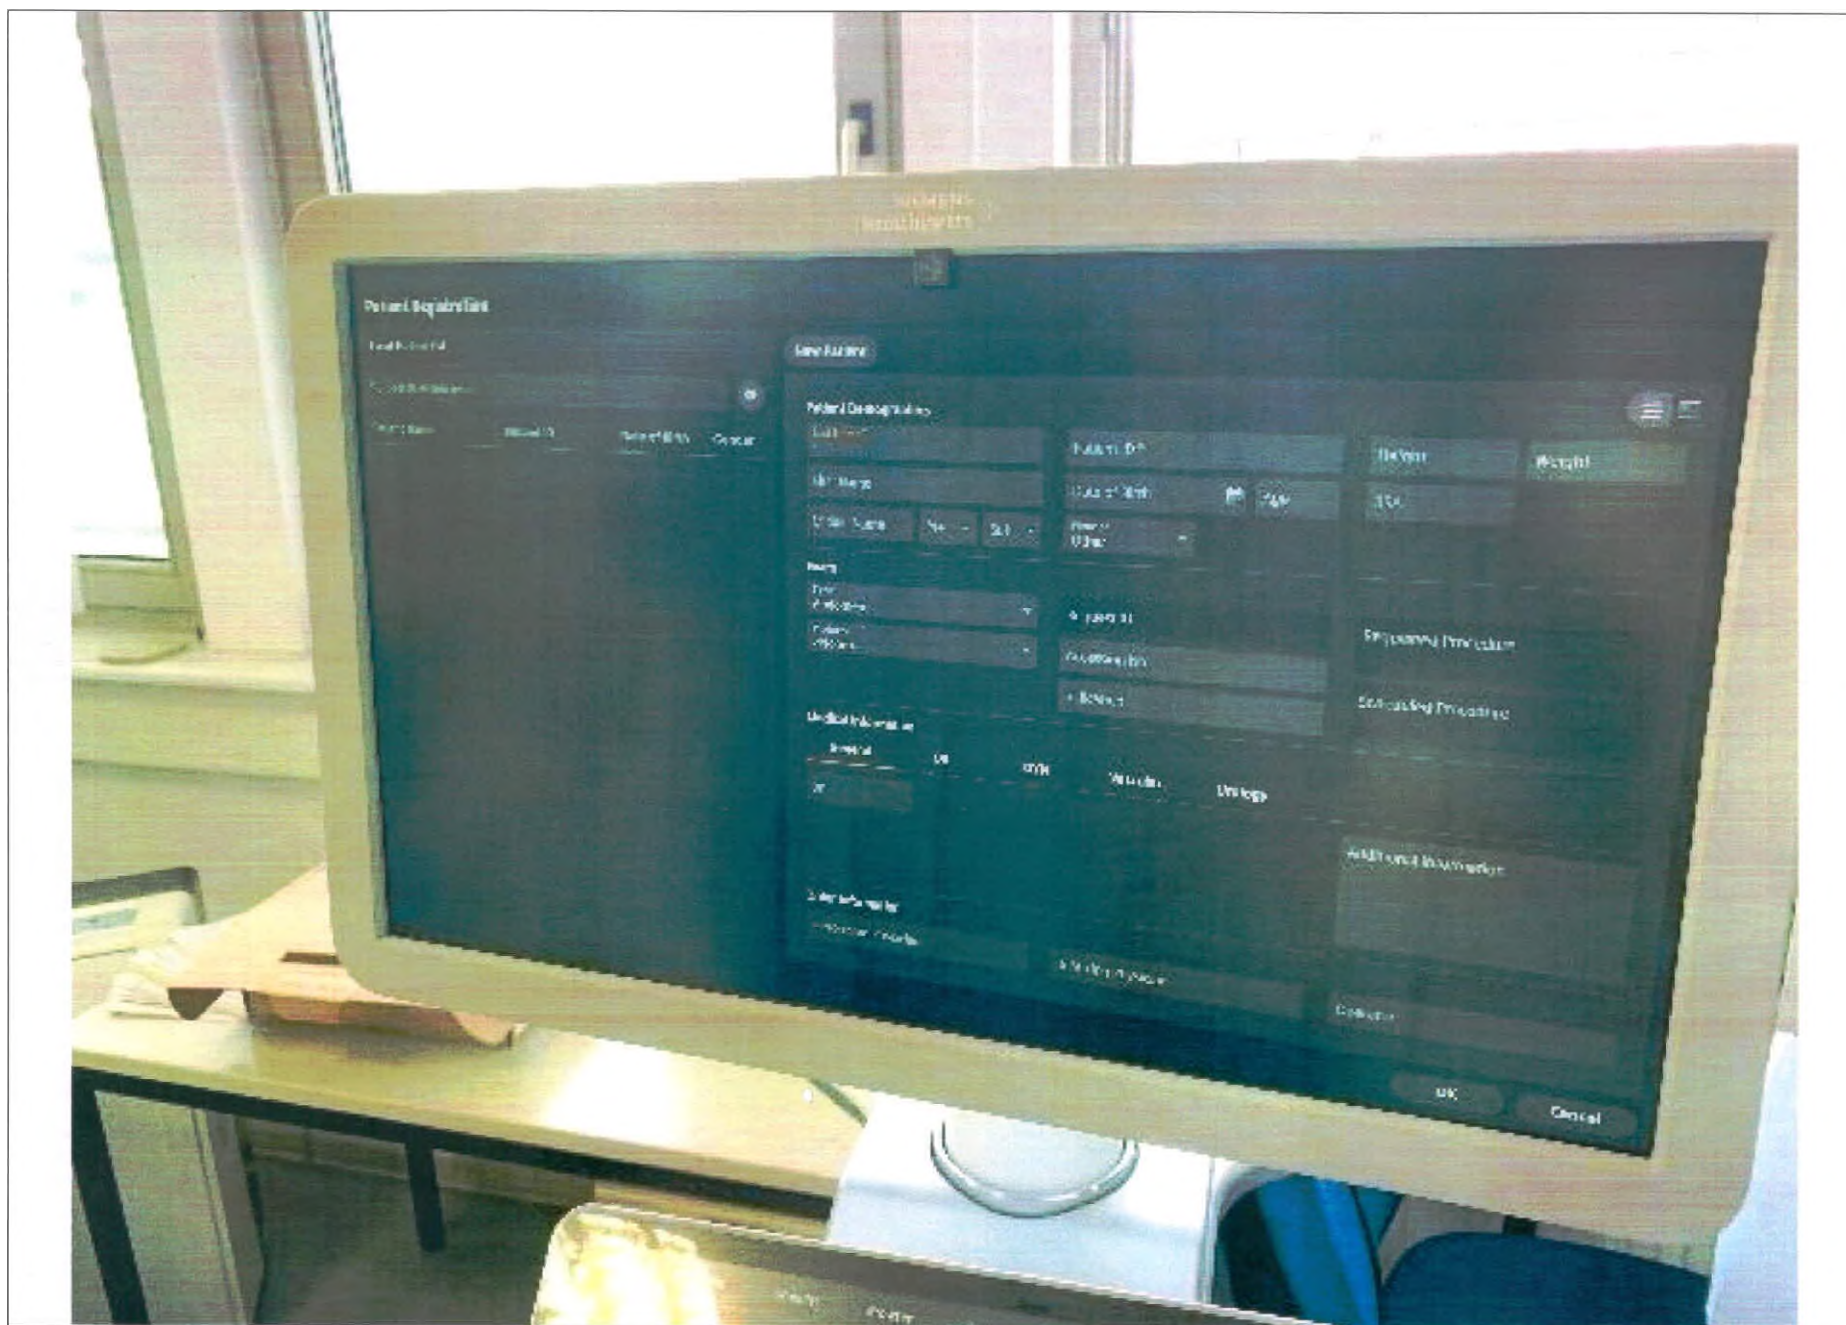


2. Системное программное обеспечение.




3. Операционная система.

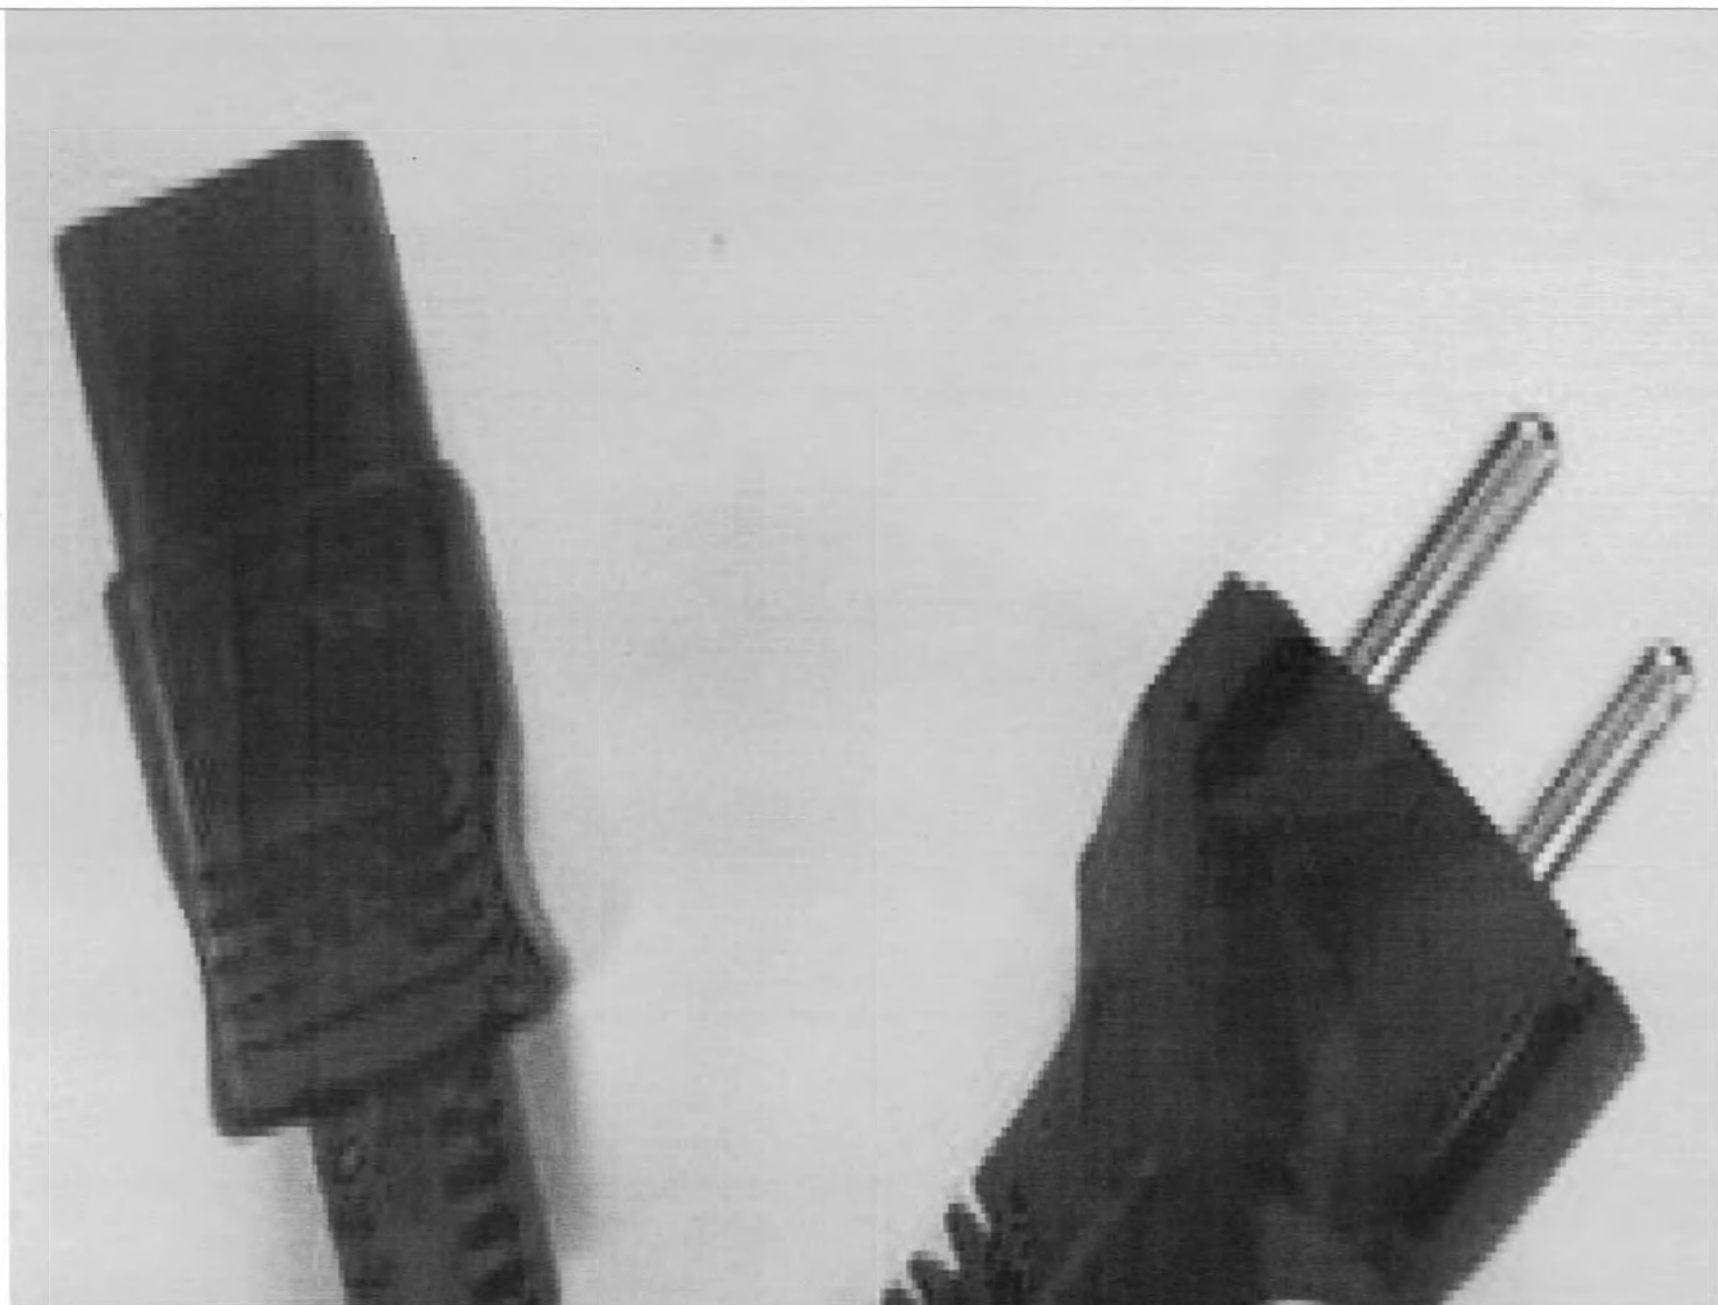


4. Кабель питания.

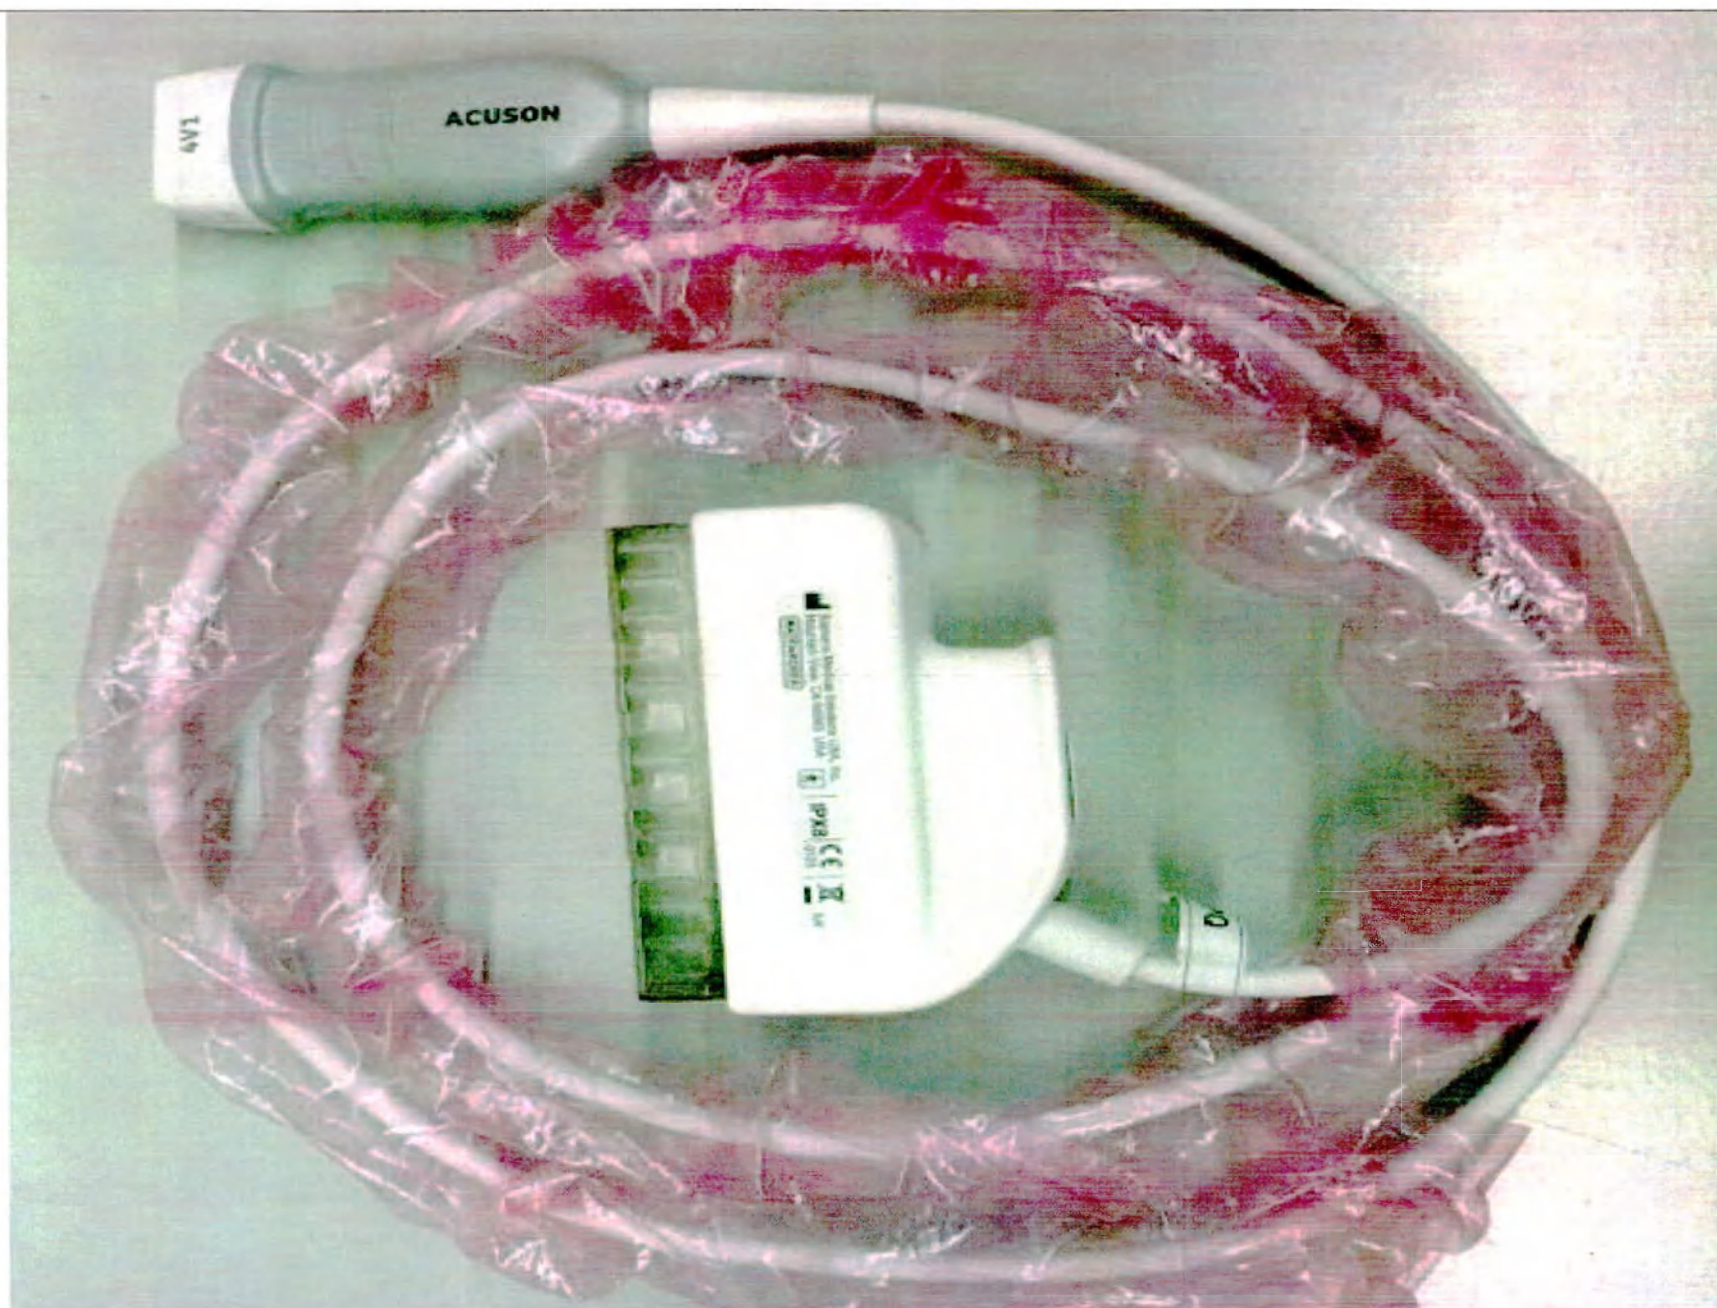

5. Датчик матричный с фазированной решеткой 4V1

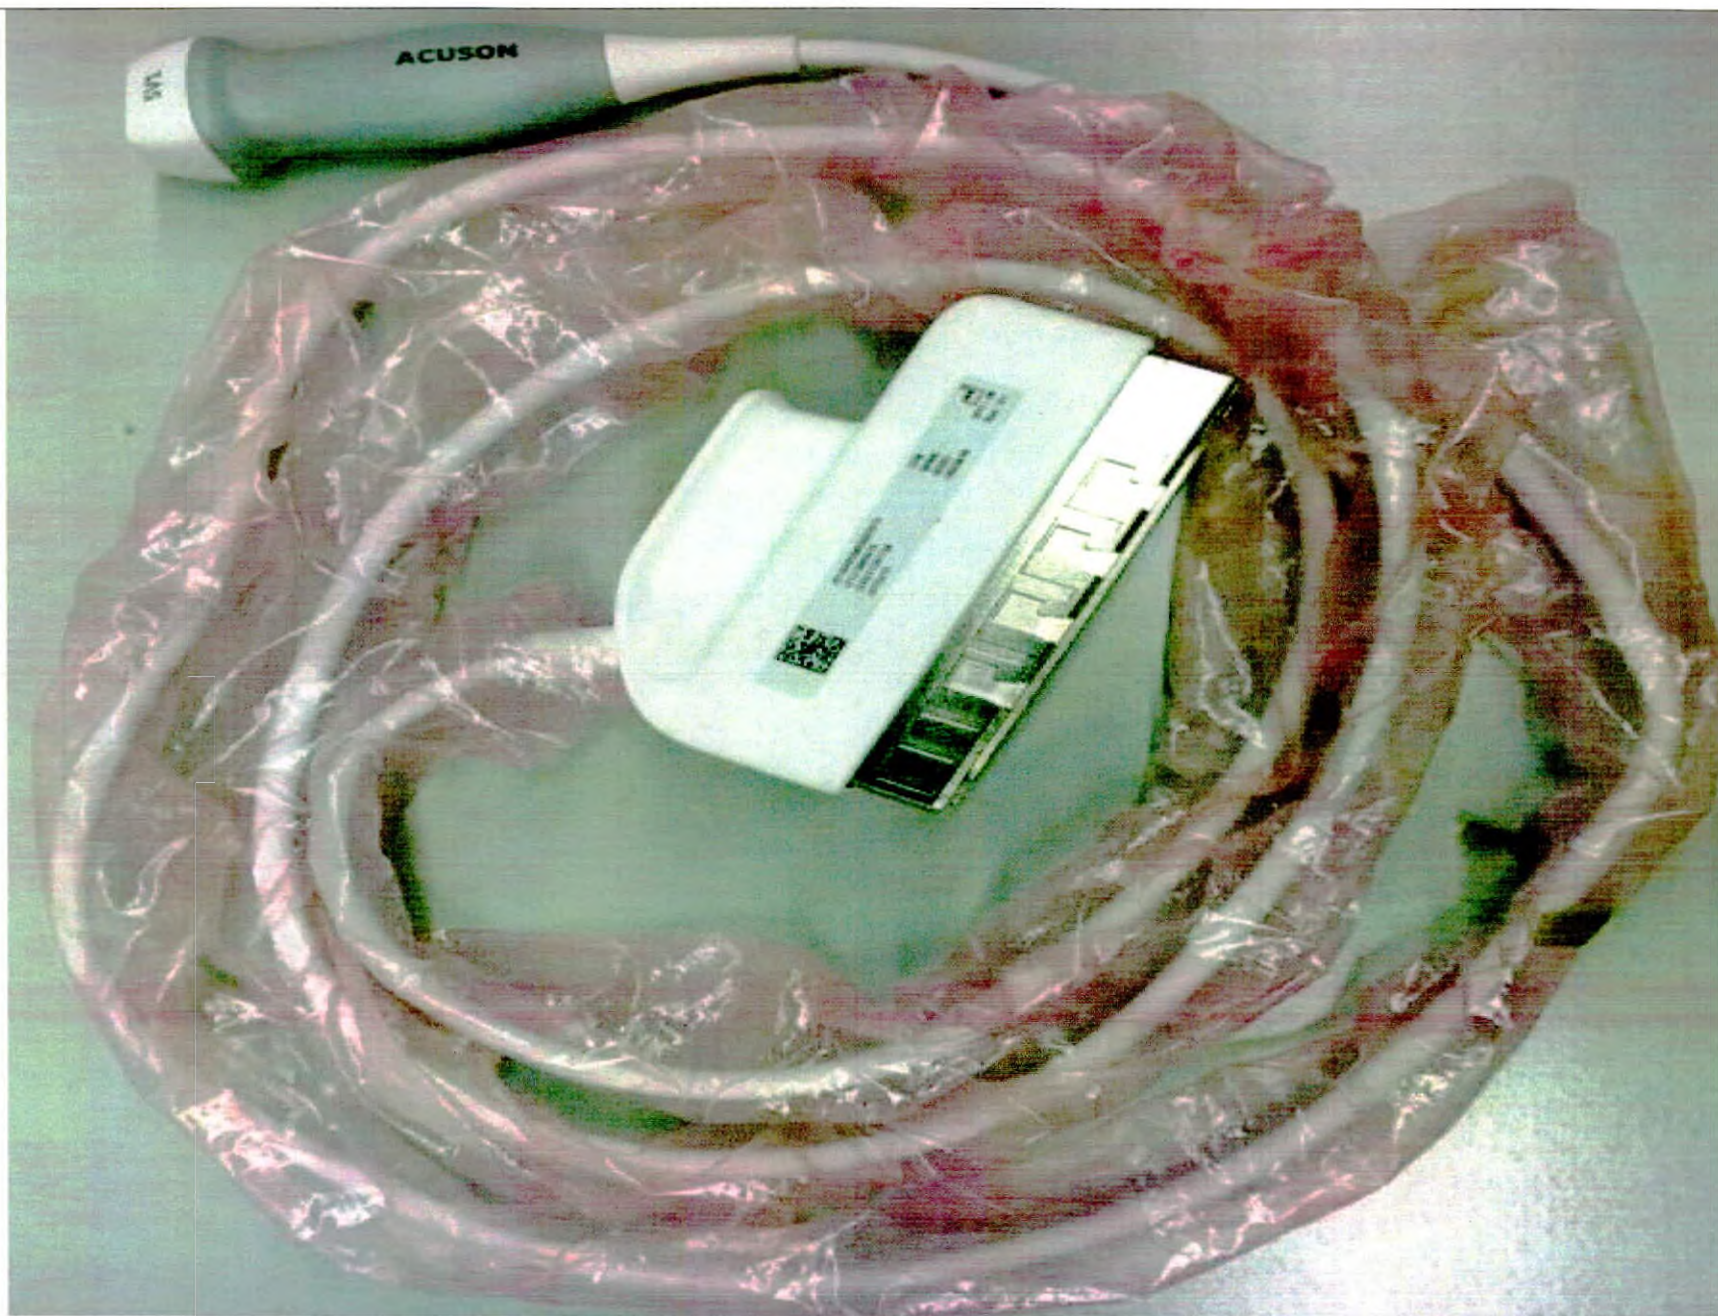


6. Датчик матричный с фазированной решеткой 5V1

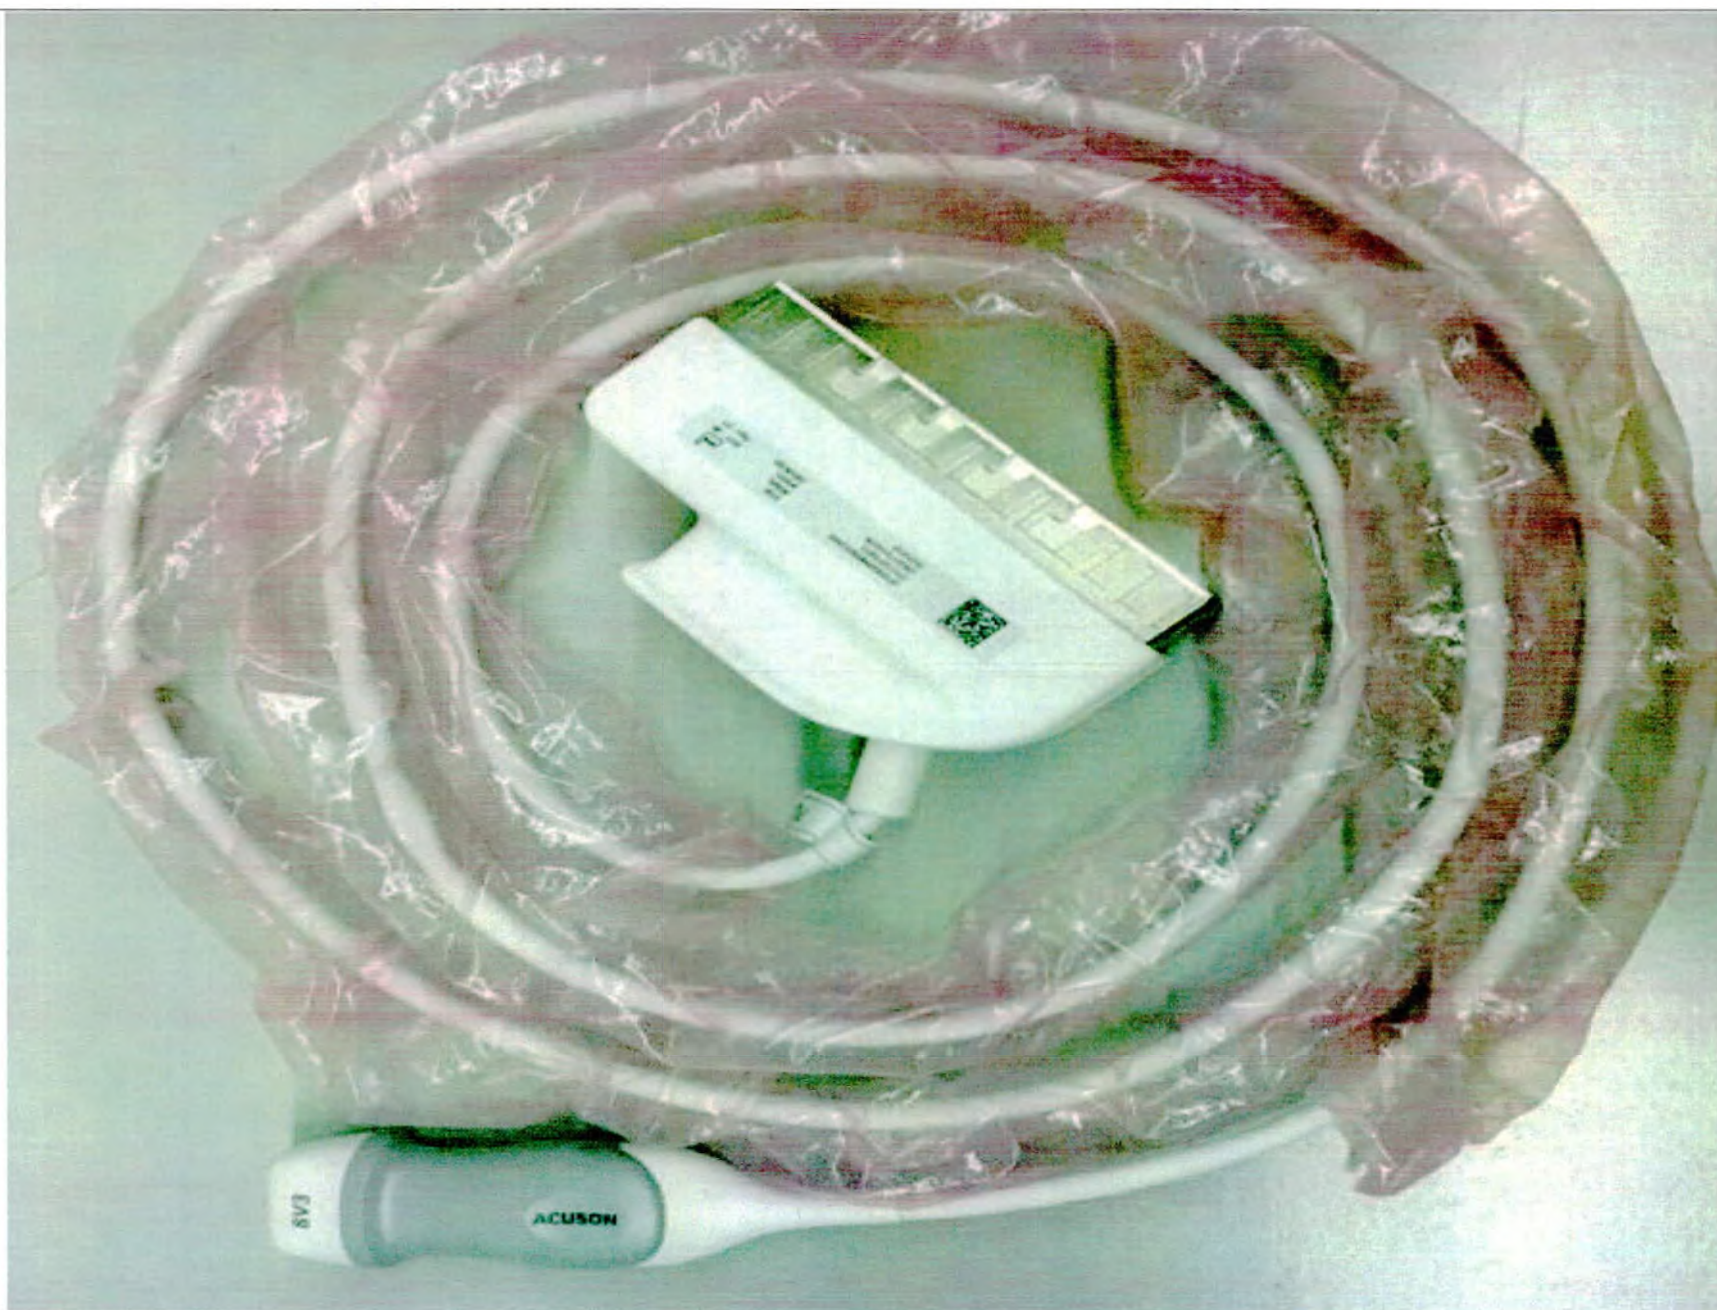

7. Датчик матричный с фазированной решеткой 8V3



8. Датчик матричный с фазированной решеткой 10V4

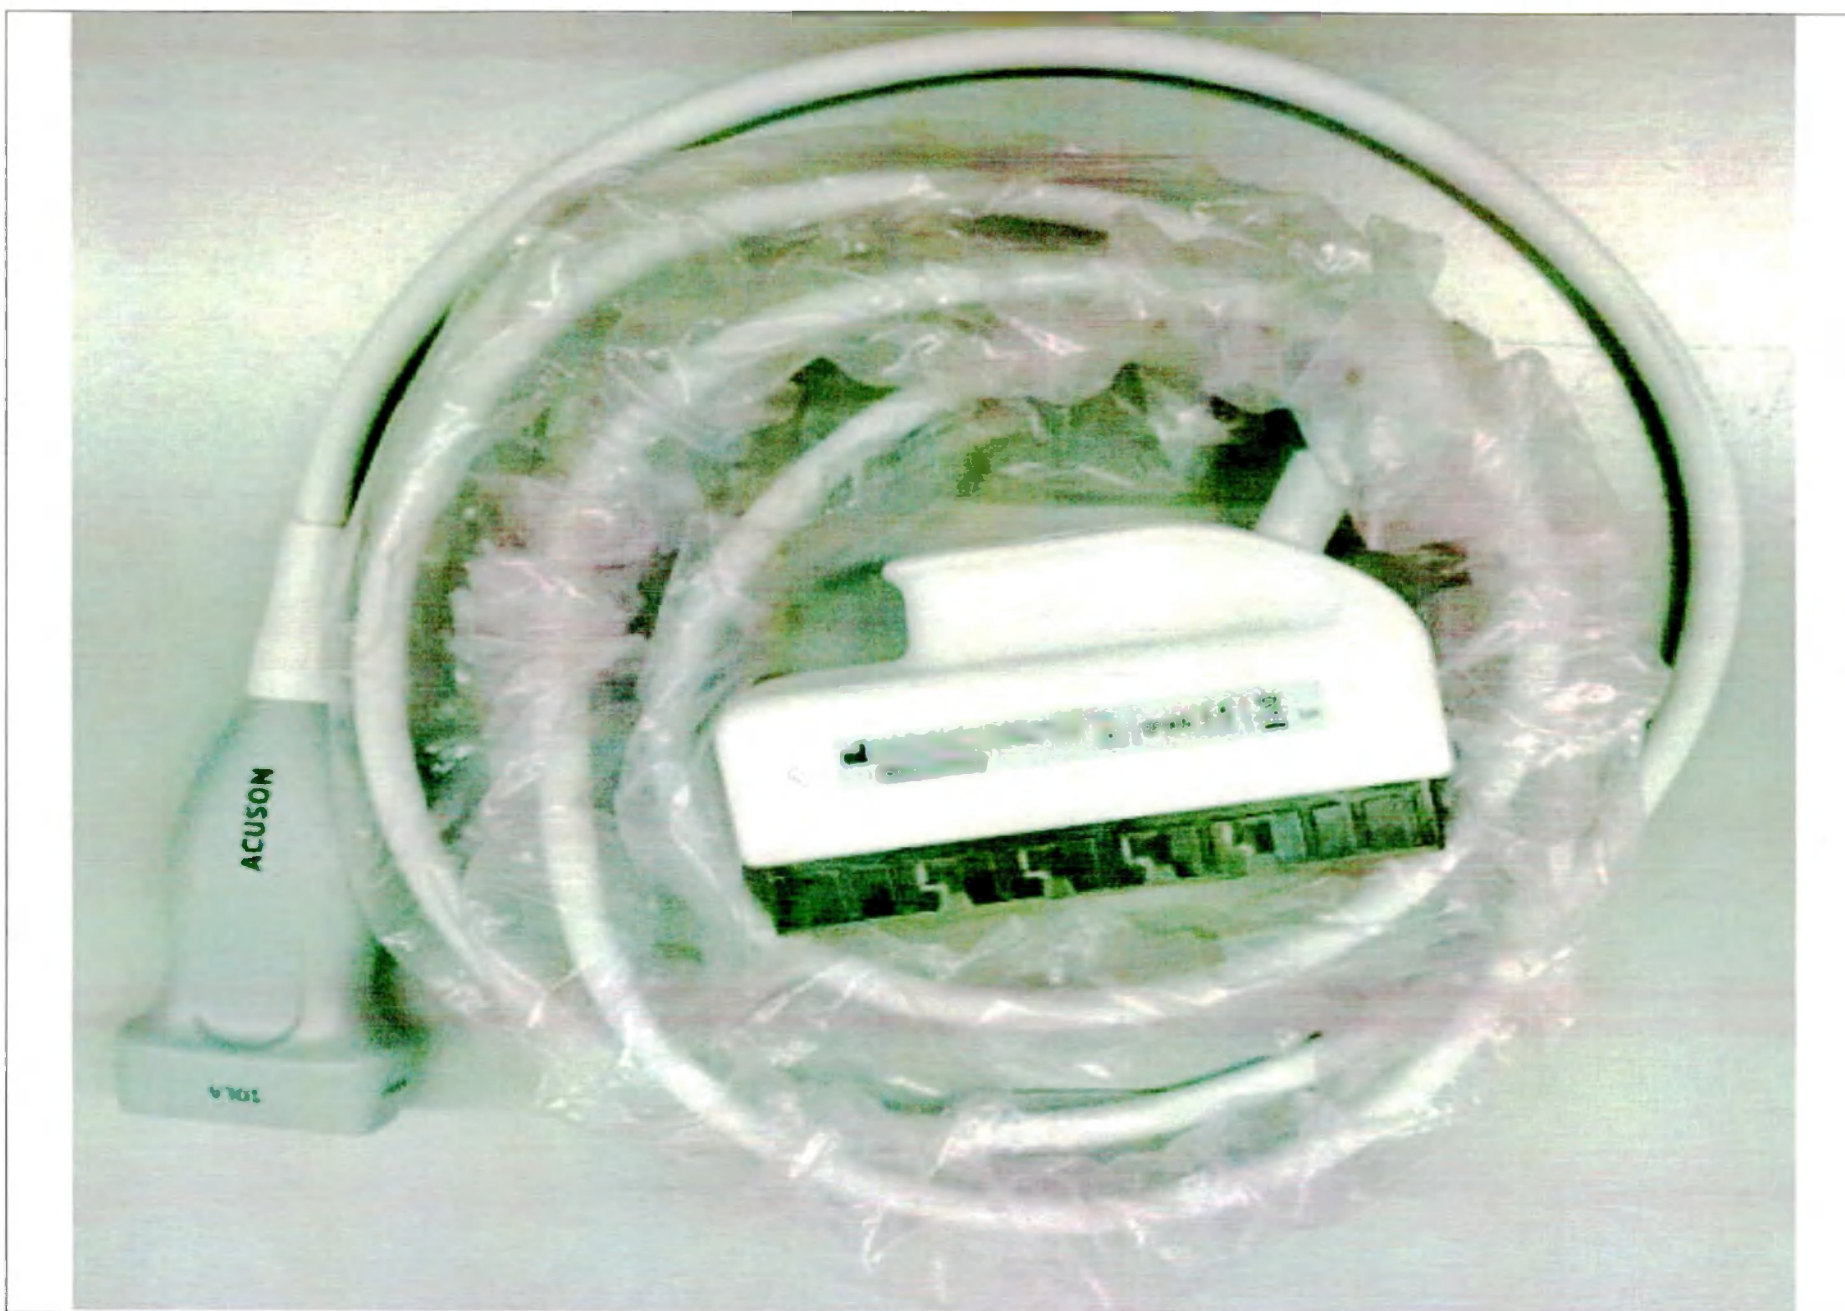

9. Датчик линейный матричный 10L4



10. Датчик линейный матричный 14L5



11. Датчик линейный матричный 18L6




12. Датчик конвексный матричный 5C1



13. Датчик конвексный матричный 9C3



14. Датчик непрерывно – волновой CW2

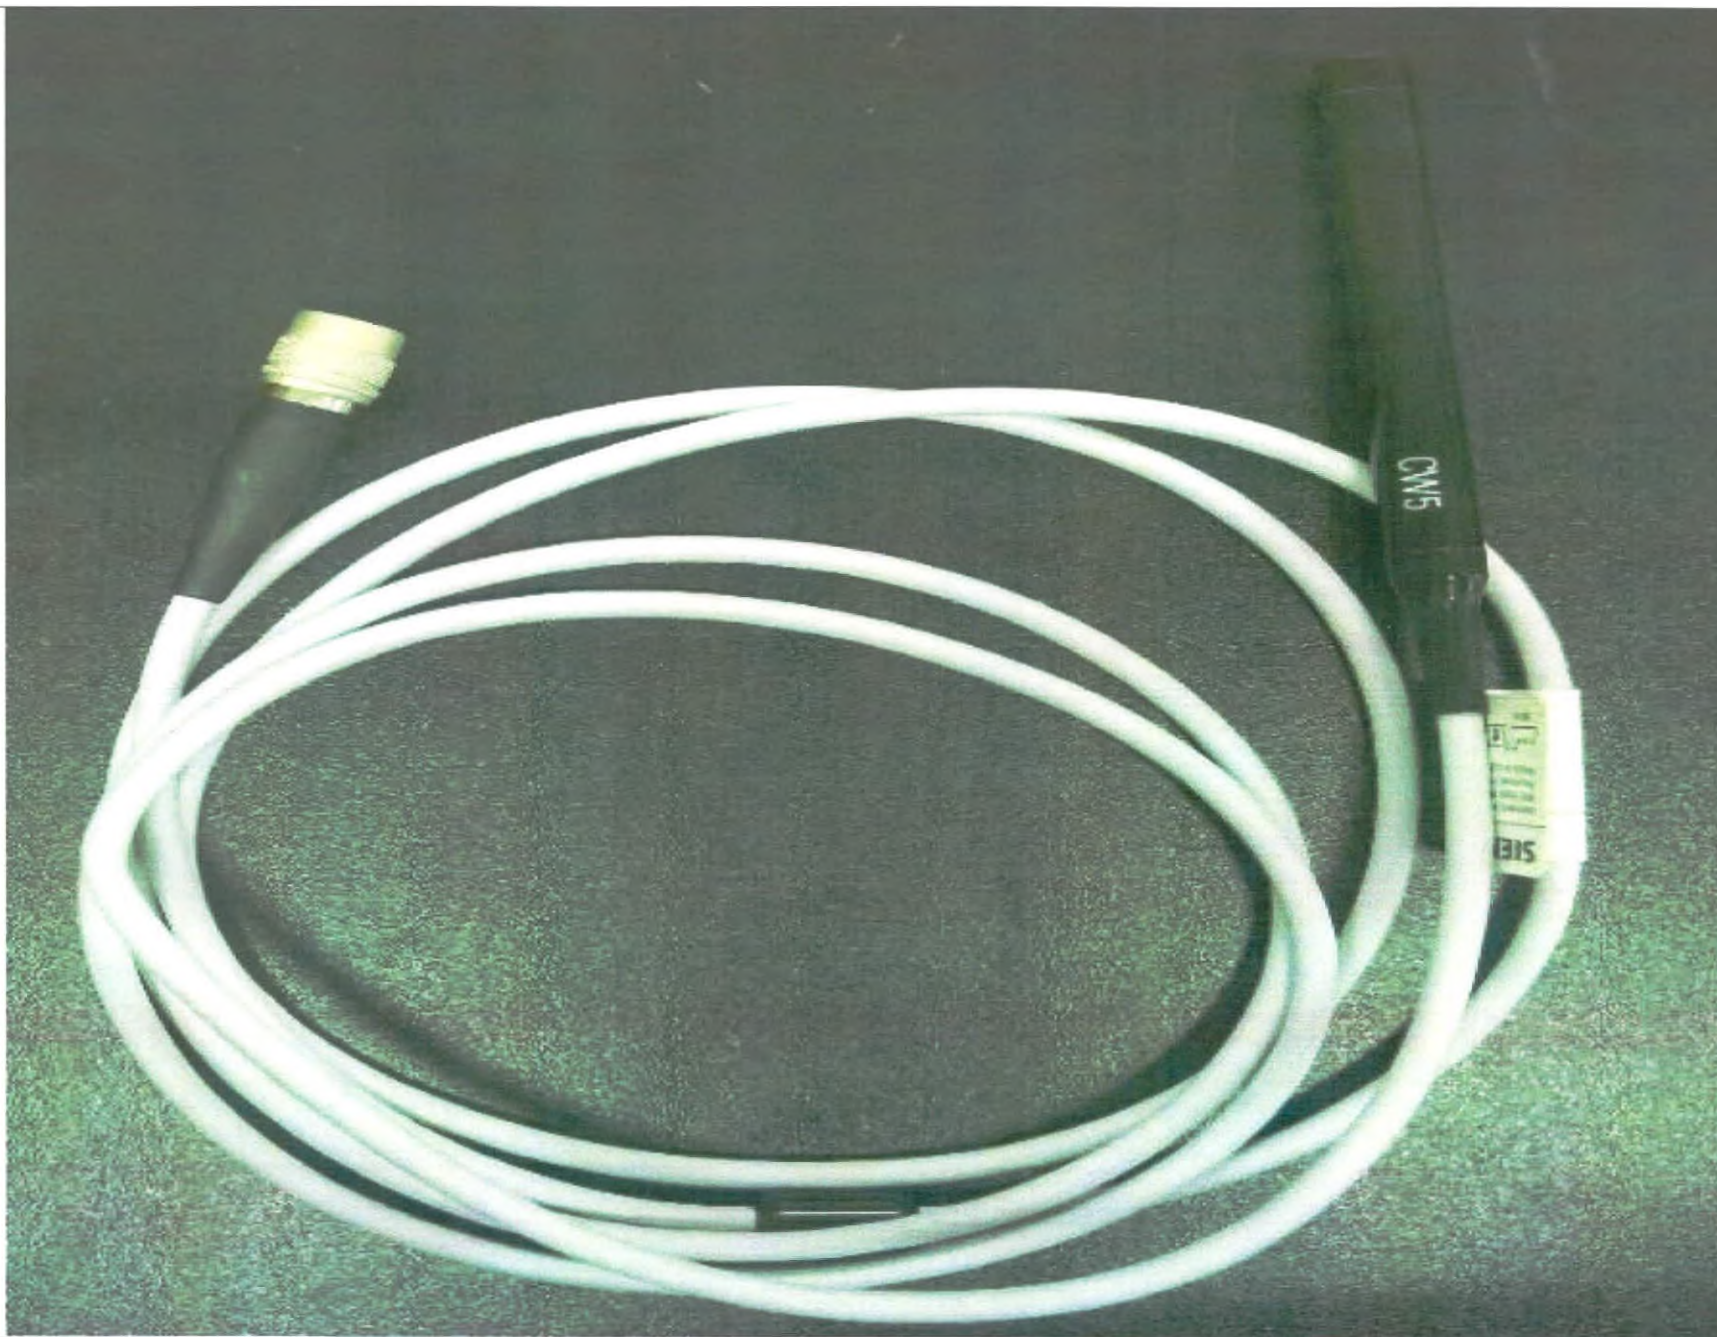


15. Датчик непрерывно – волновой CW5



16. Датчик внутриполостной 9EC4, для ректо-вагинальных исследований



17. Датчик фазированный матричный V5Ms, для чреспищеводных исследований

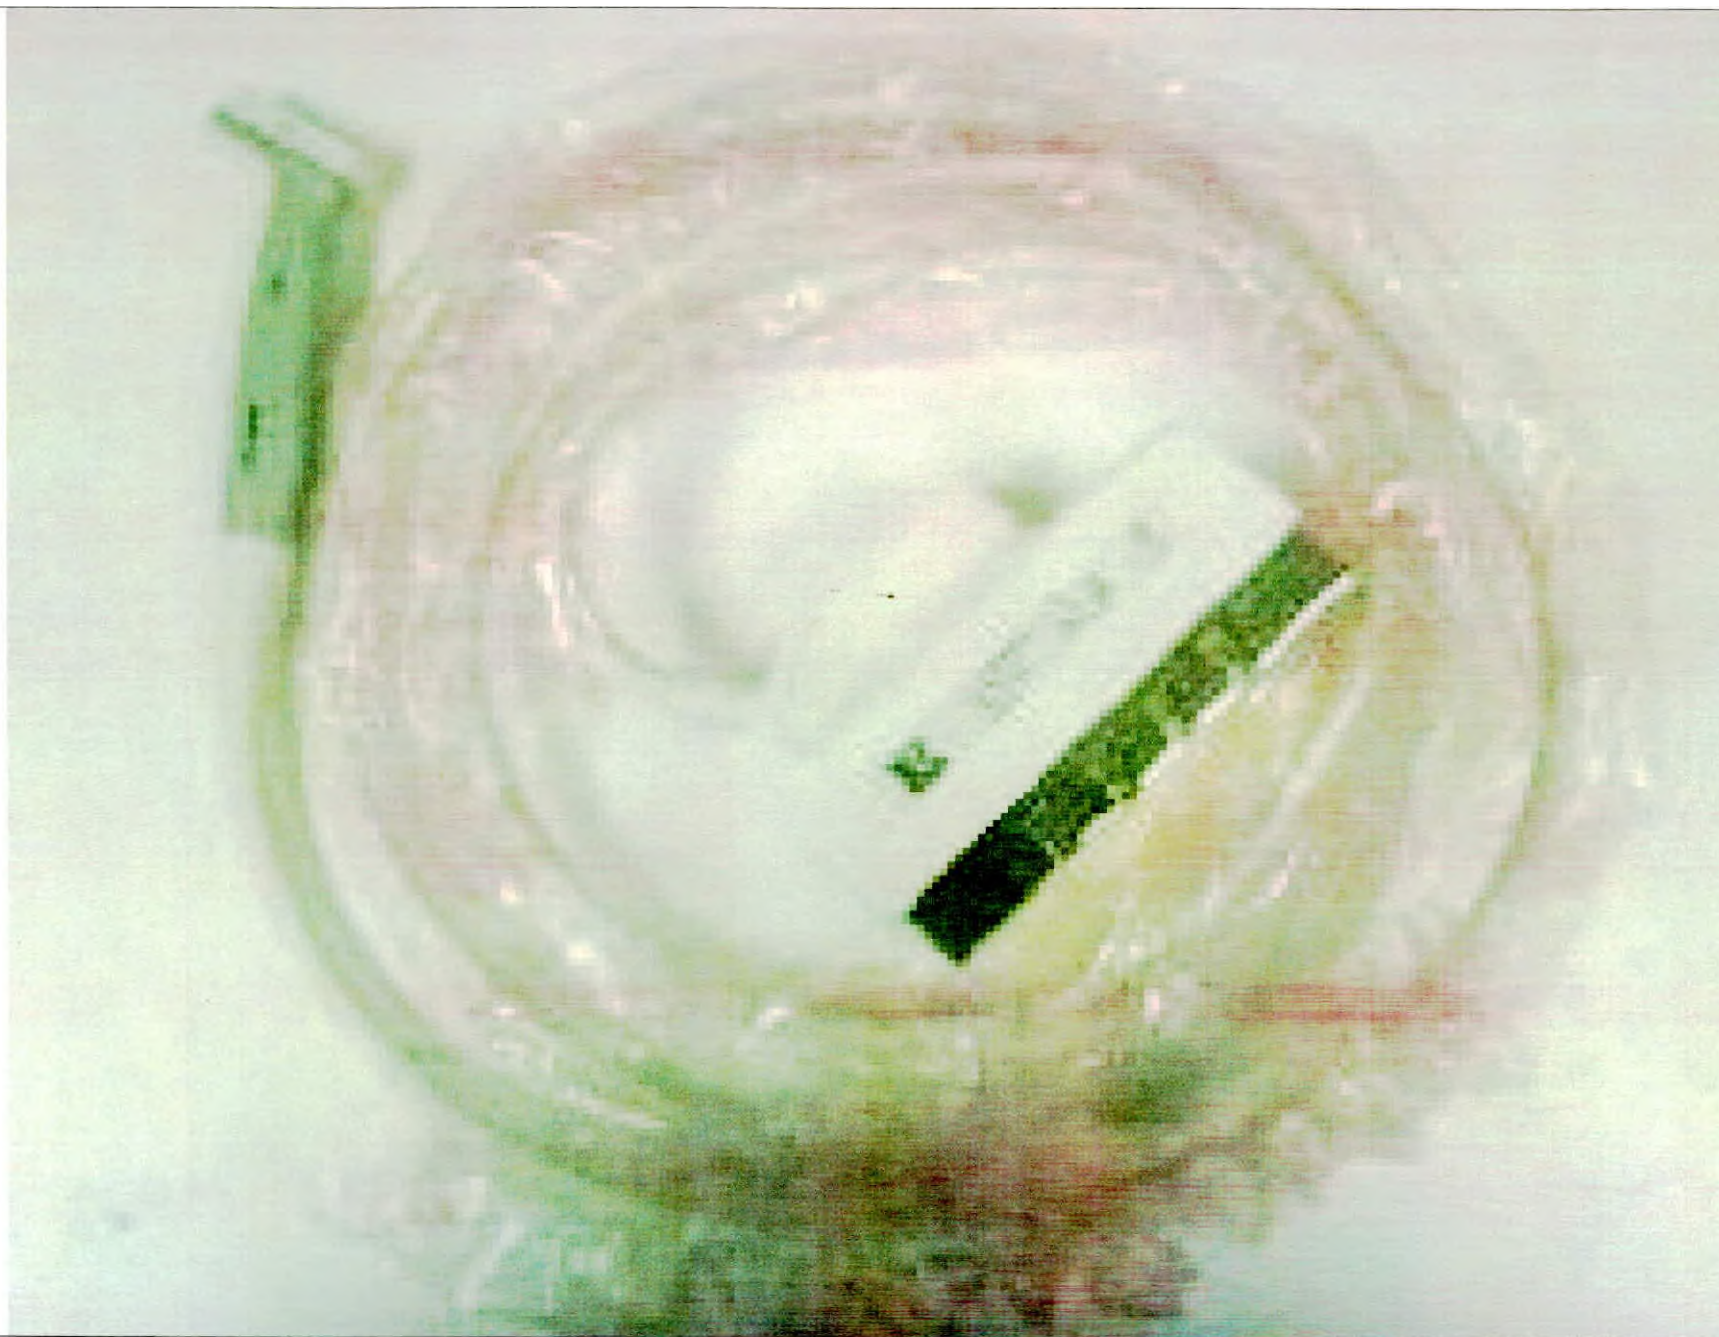


18. Датчик линейный матричный 18Н6, интраоперационный



19. Датчик TVC2 конвексный объемный



20. Датчик 9VE4 внутриполостной объемный

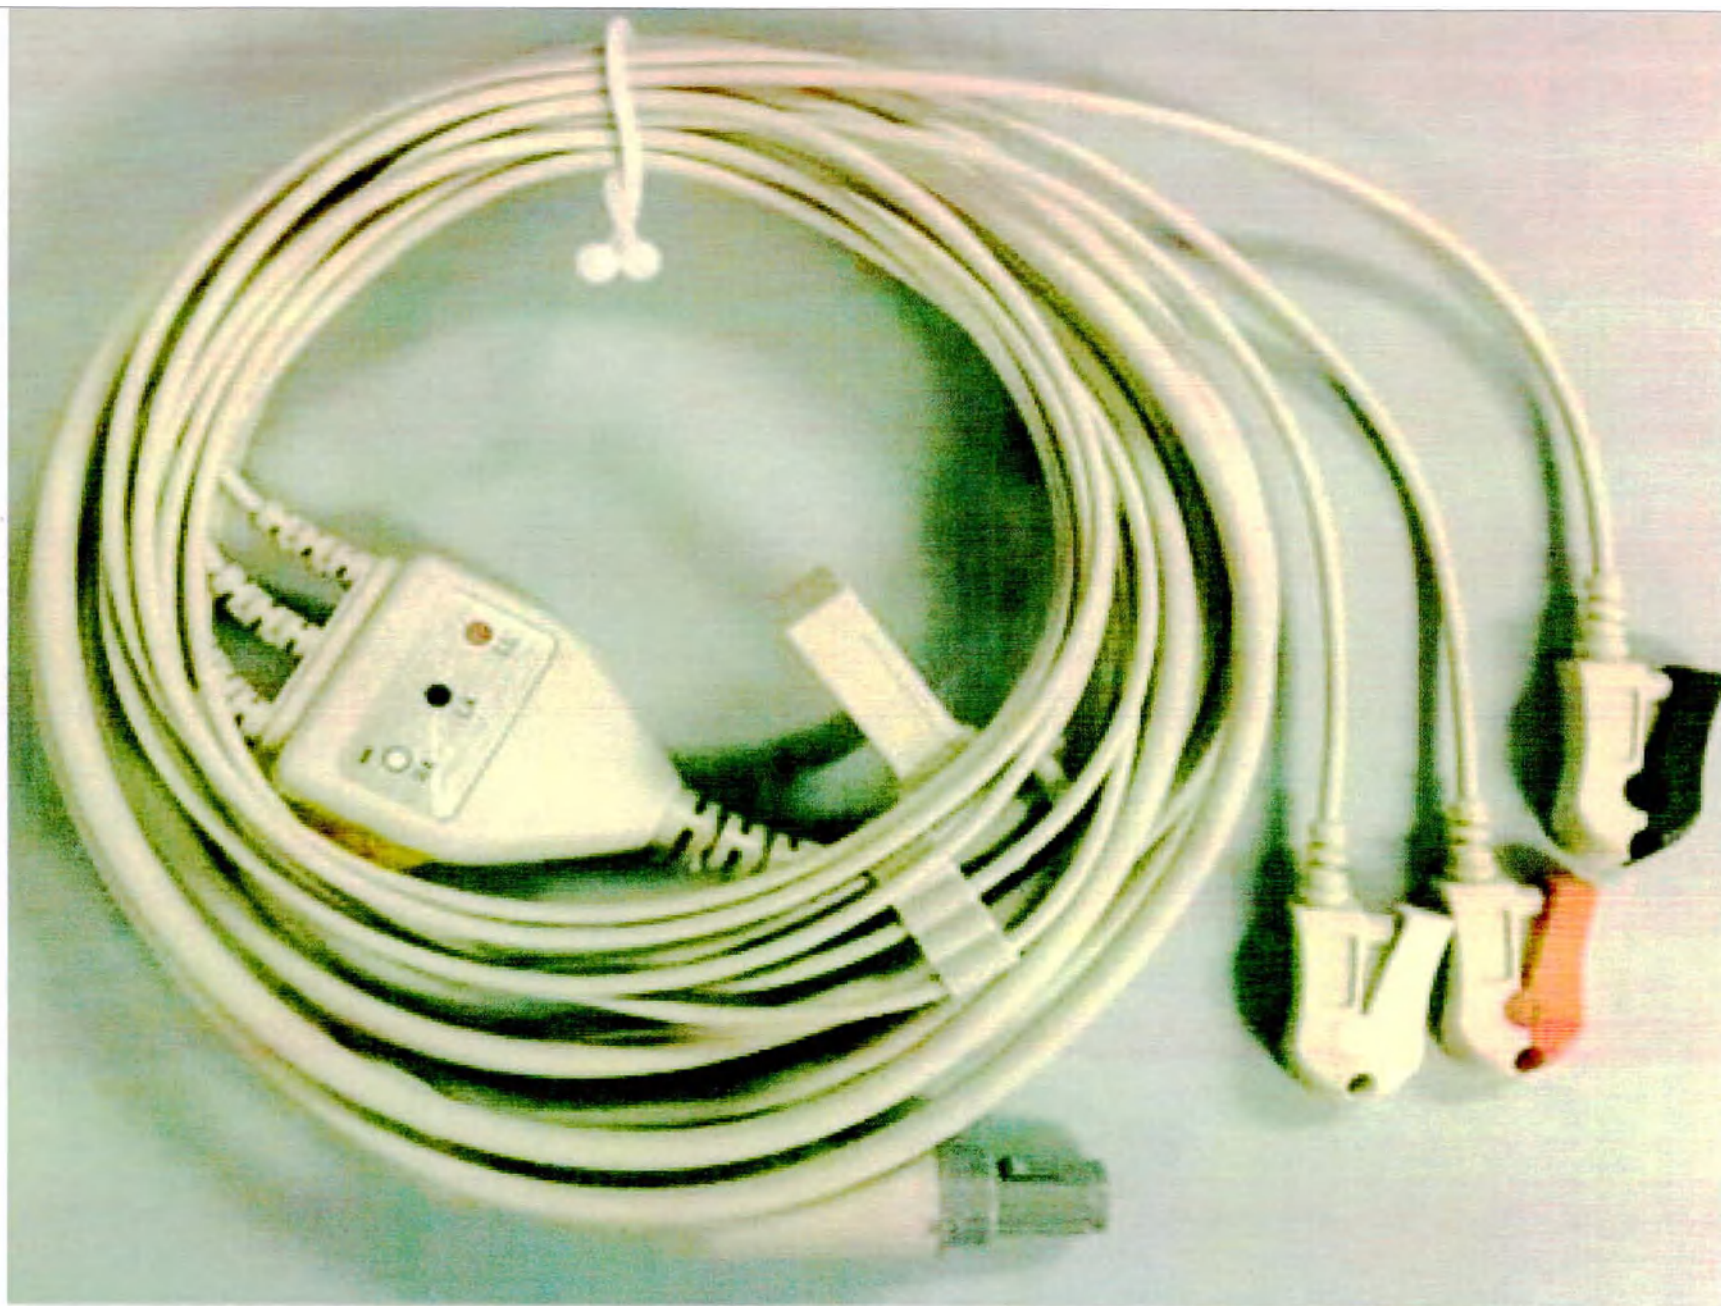

21.

Кабель ЭКГ (европейский стандарт на три отведения)


ACUSON Redwood
Диагностическая ультразвуковая система
Инструкция по эксплуатации
US




ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:



1. Лицензионный ключ для опции визуализации с контрастным веществом.

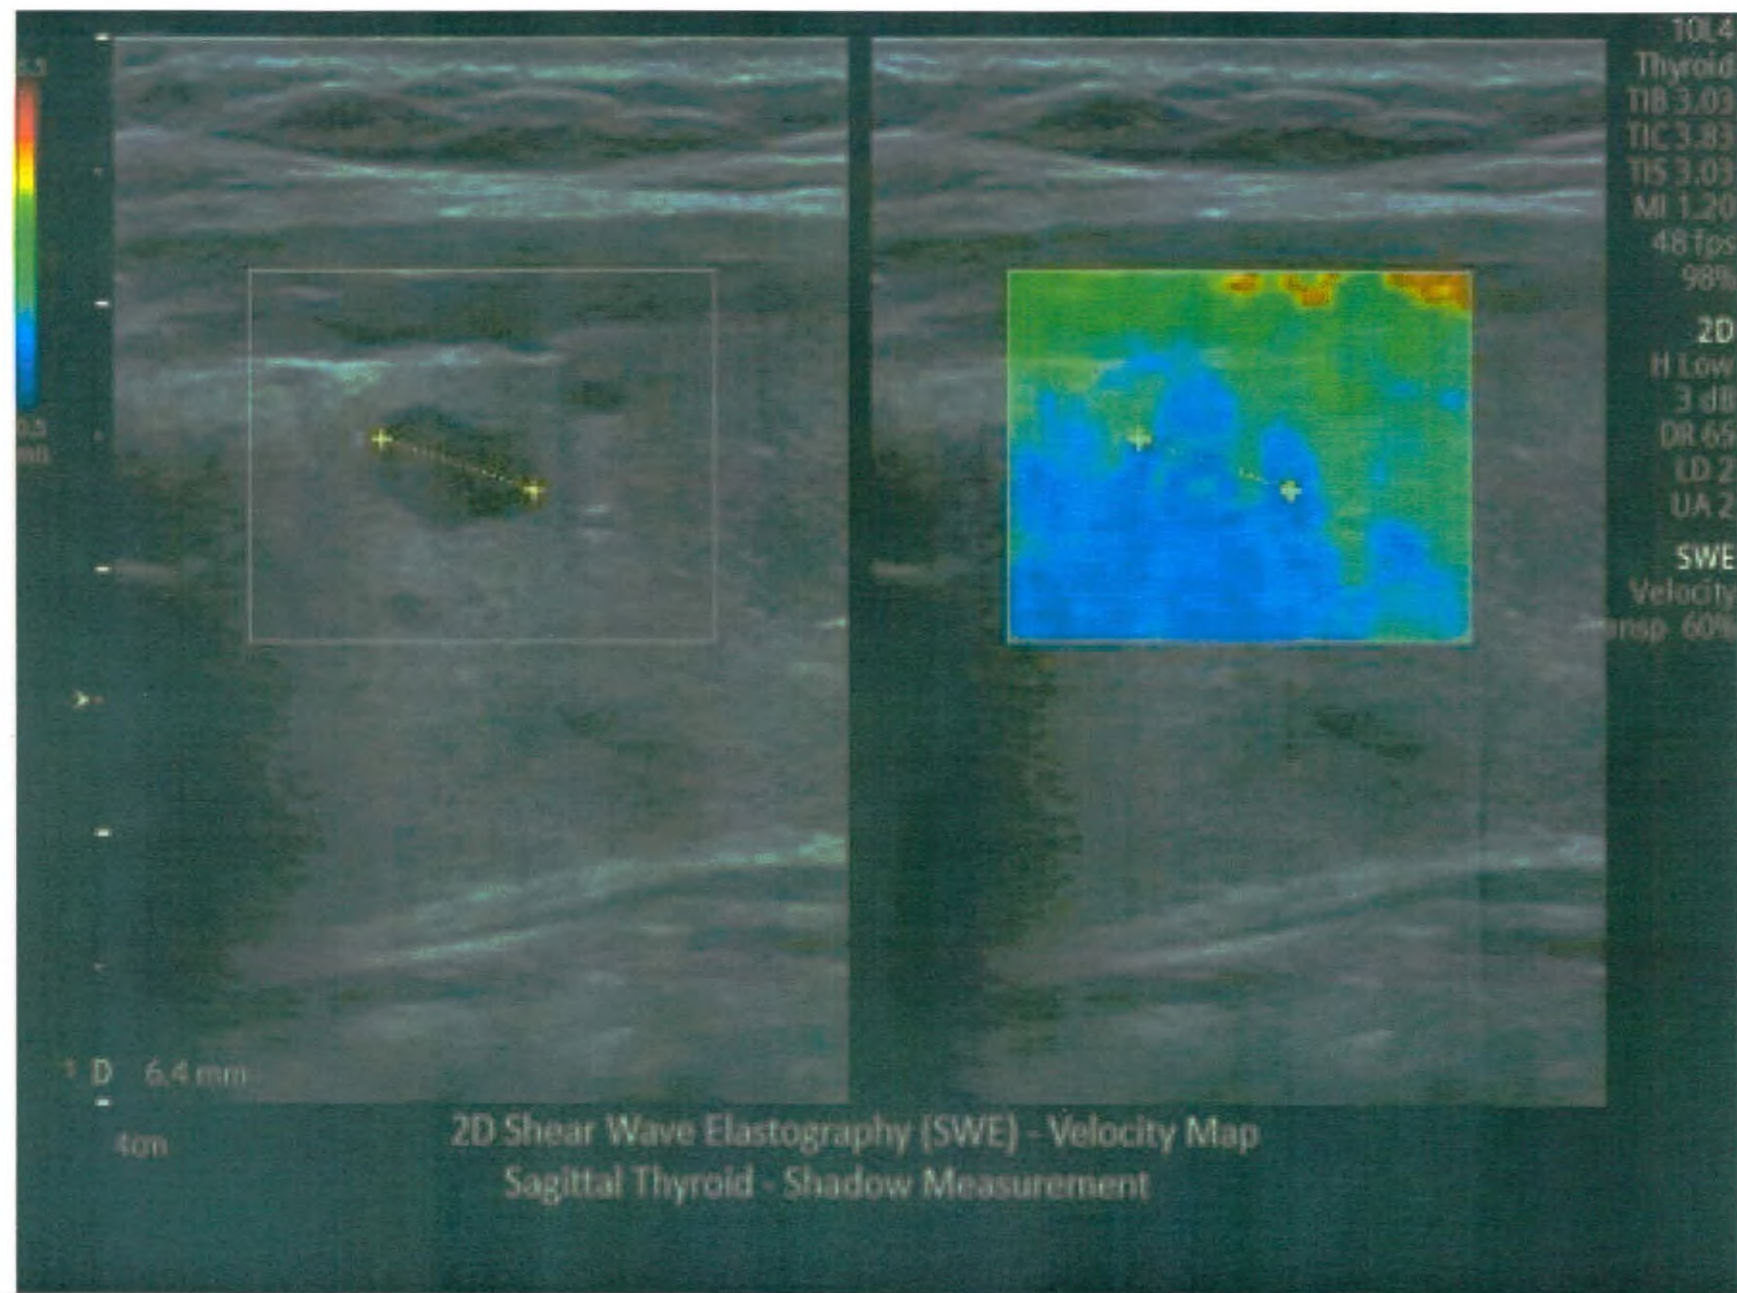


2. Лицензионный ключ для технологии визуализации эластичности ткани для линейных датчиков.

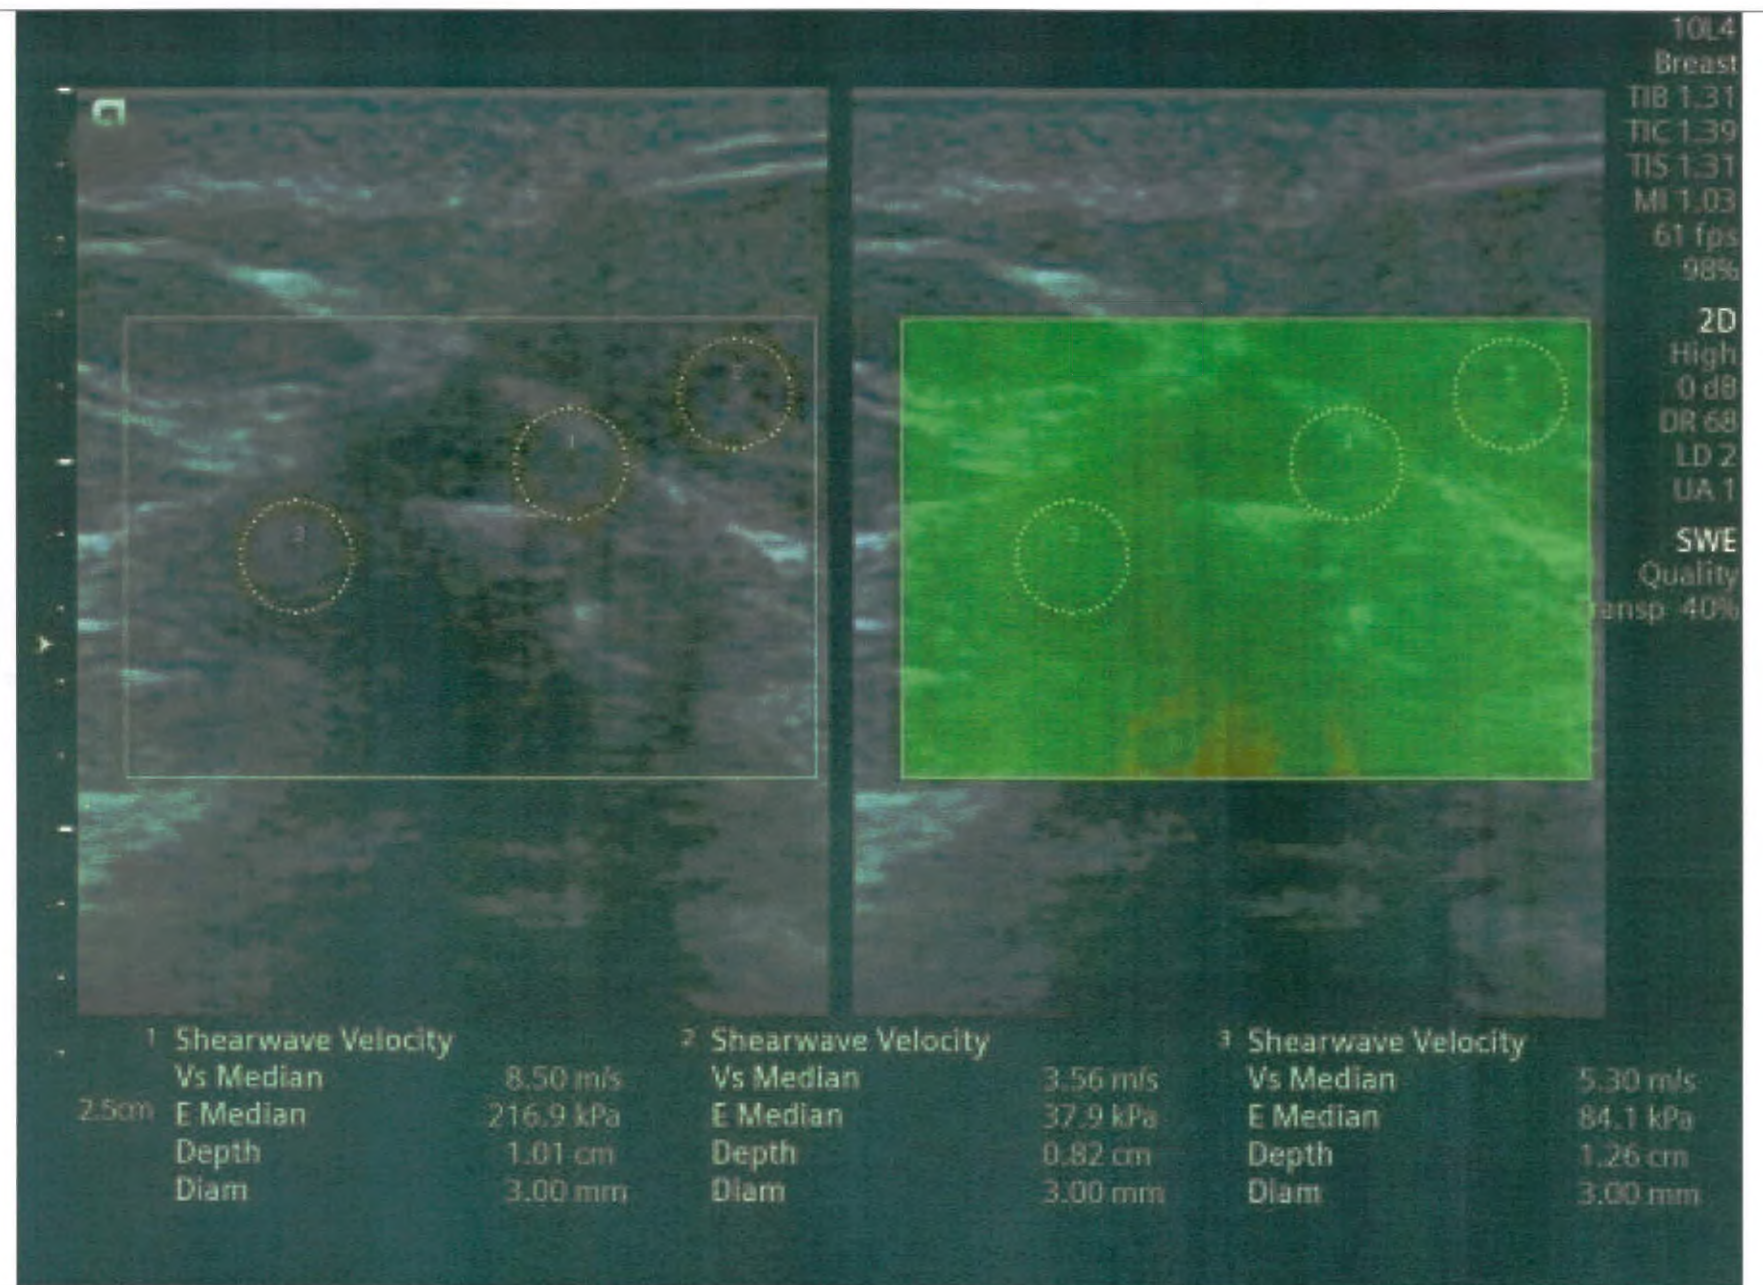


3. Лицензионный ключ для определения скорости распространения поперечной волны при работе с линейными и конвексными датчиками.




4. Лицензионный ключ для технологии качественного определения жесткости ткани в зоне интереса.

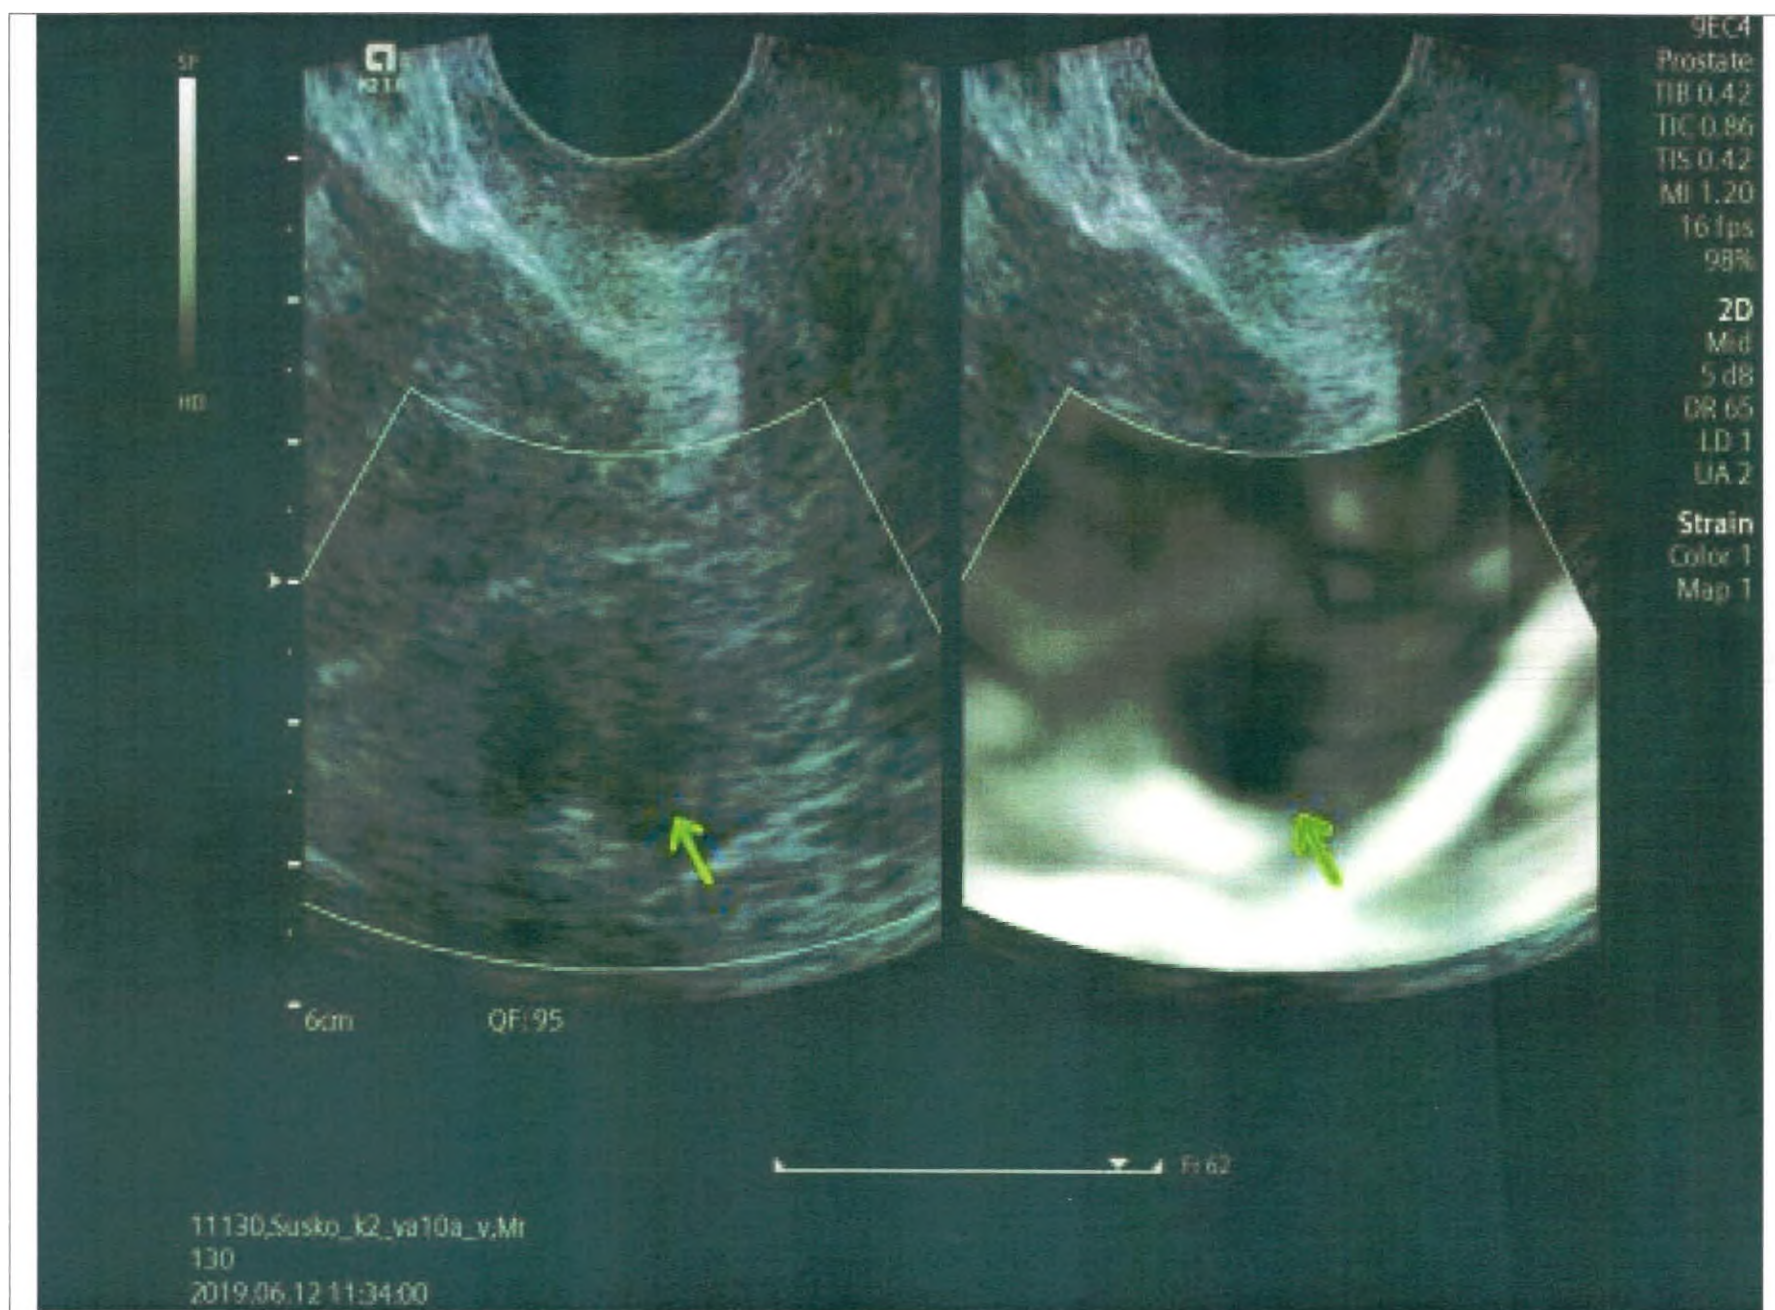

5. Лицензионный ключ для технологии визуализации эластичности ткани для внутримолостных датчиков.

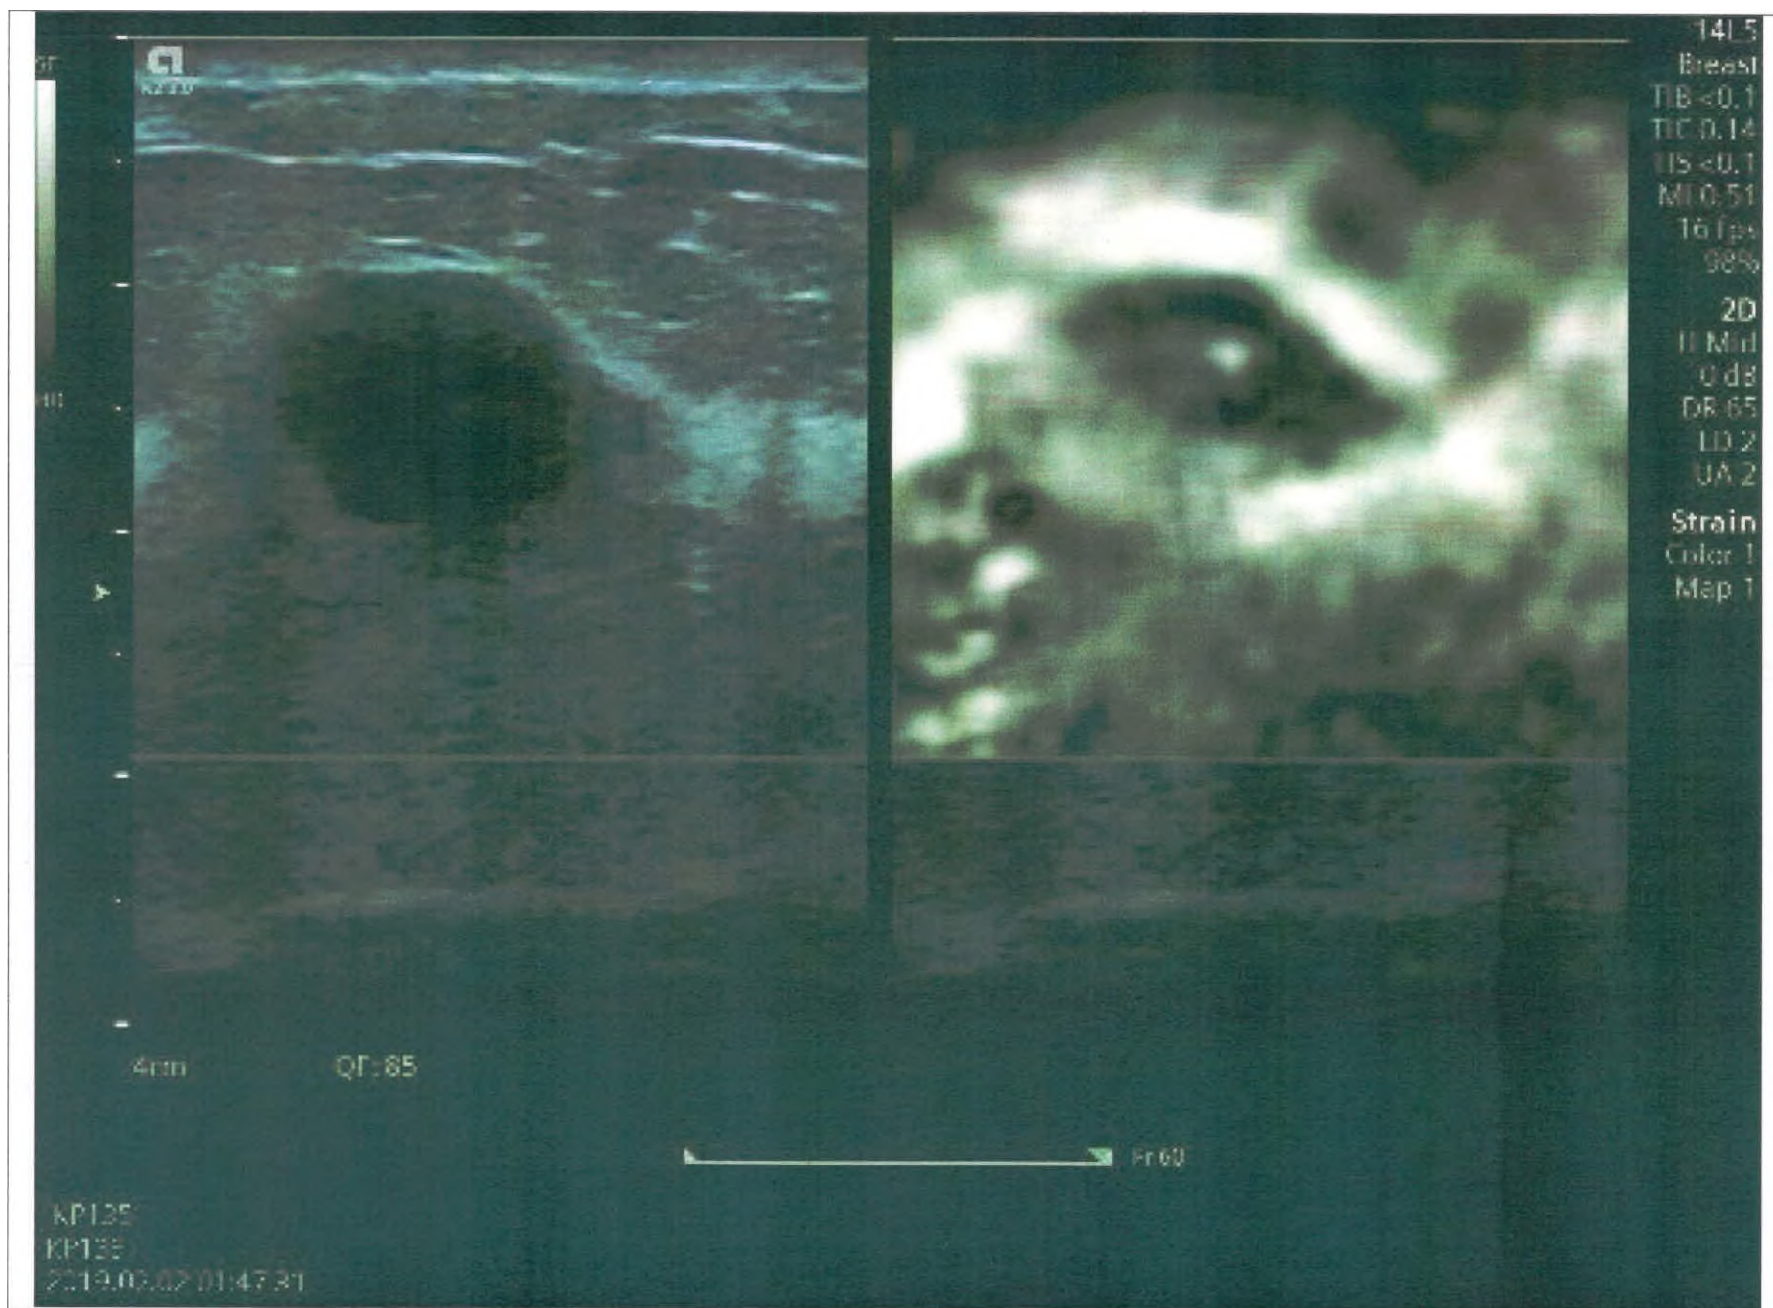

6. Лицензионный ключ для технологии эластографии.

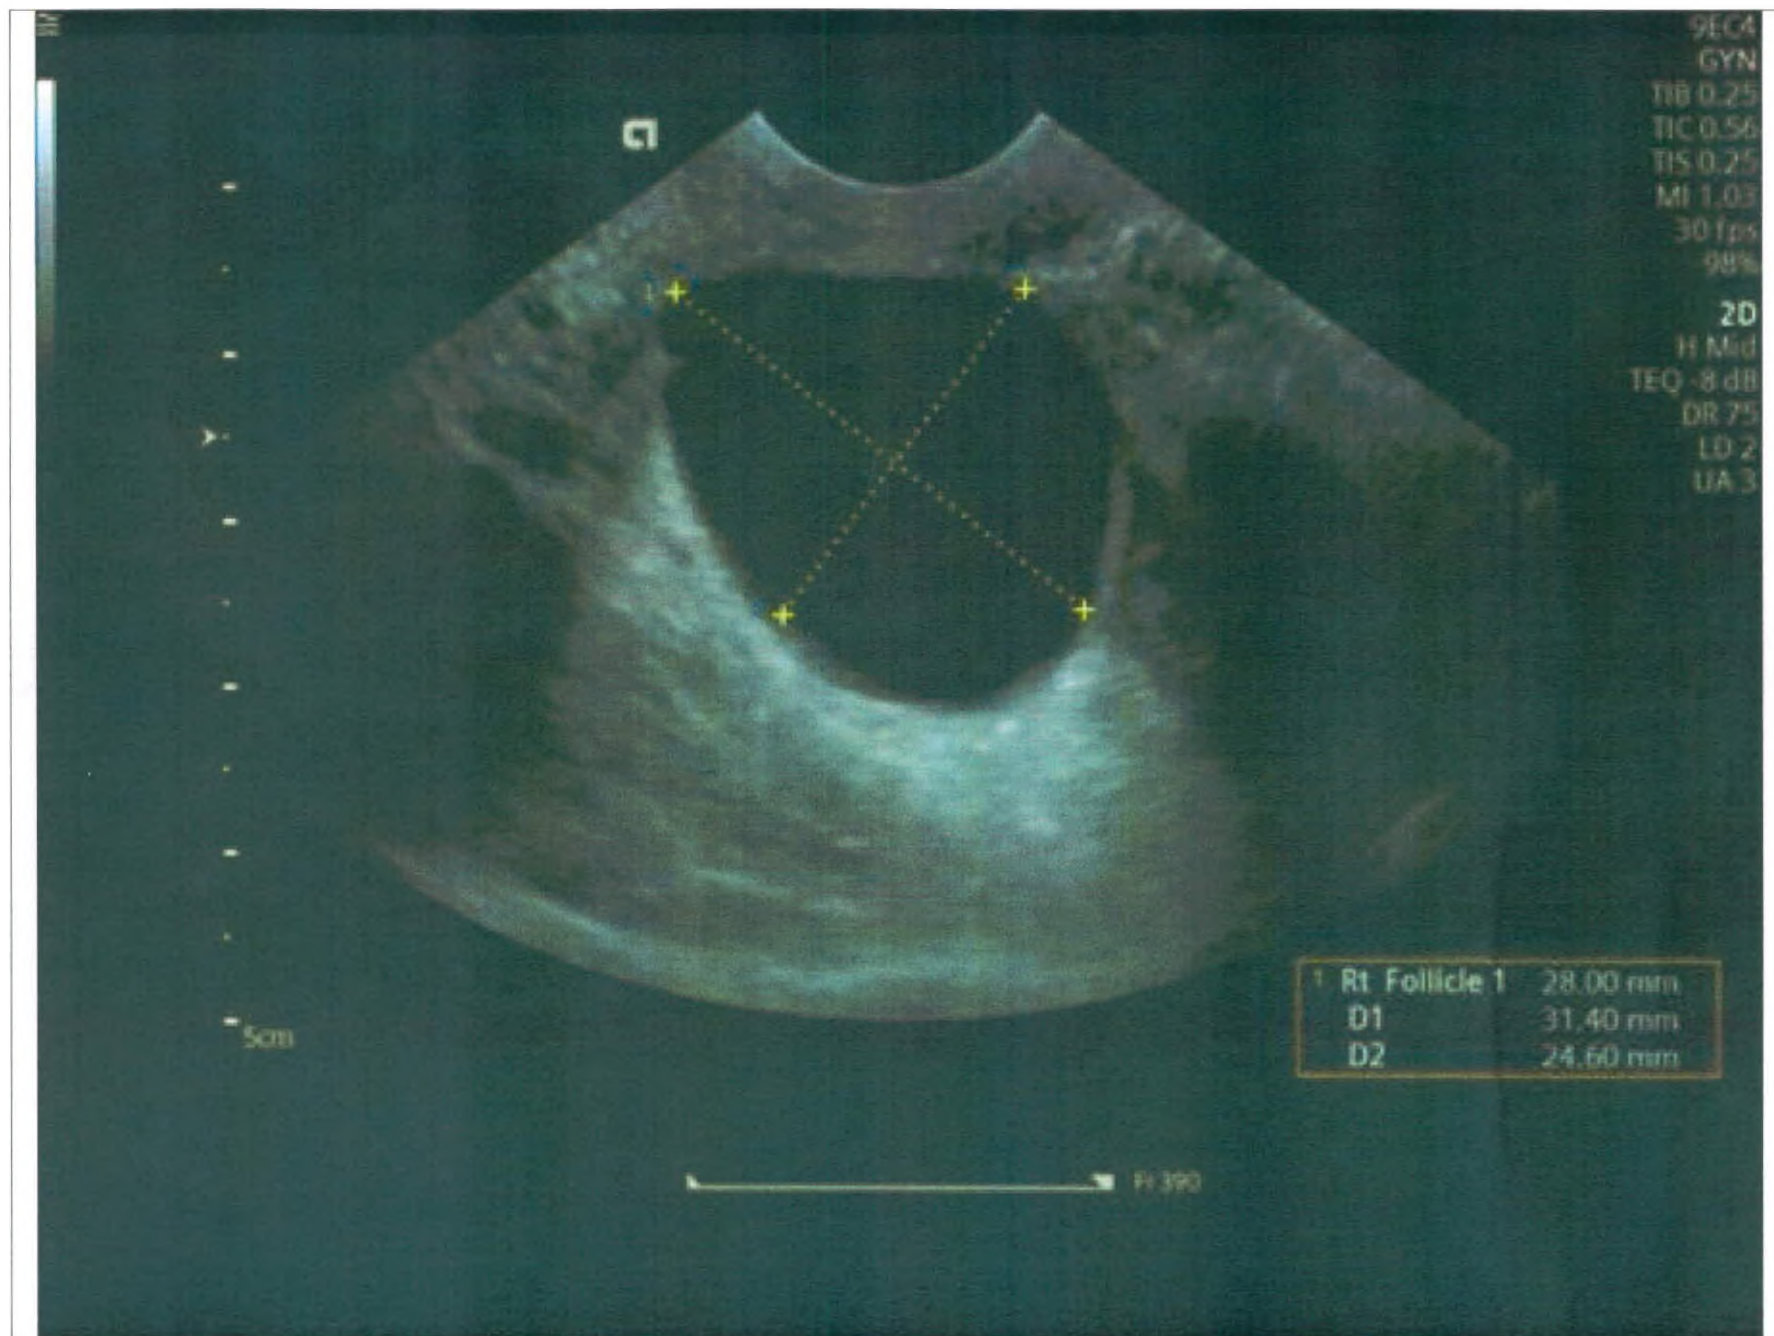


7. Лицензионный ключ для технологии автоматического исследования фолликулов.




8.


Лицензионный ключ для технологии автоматических перинатальных измерений.

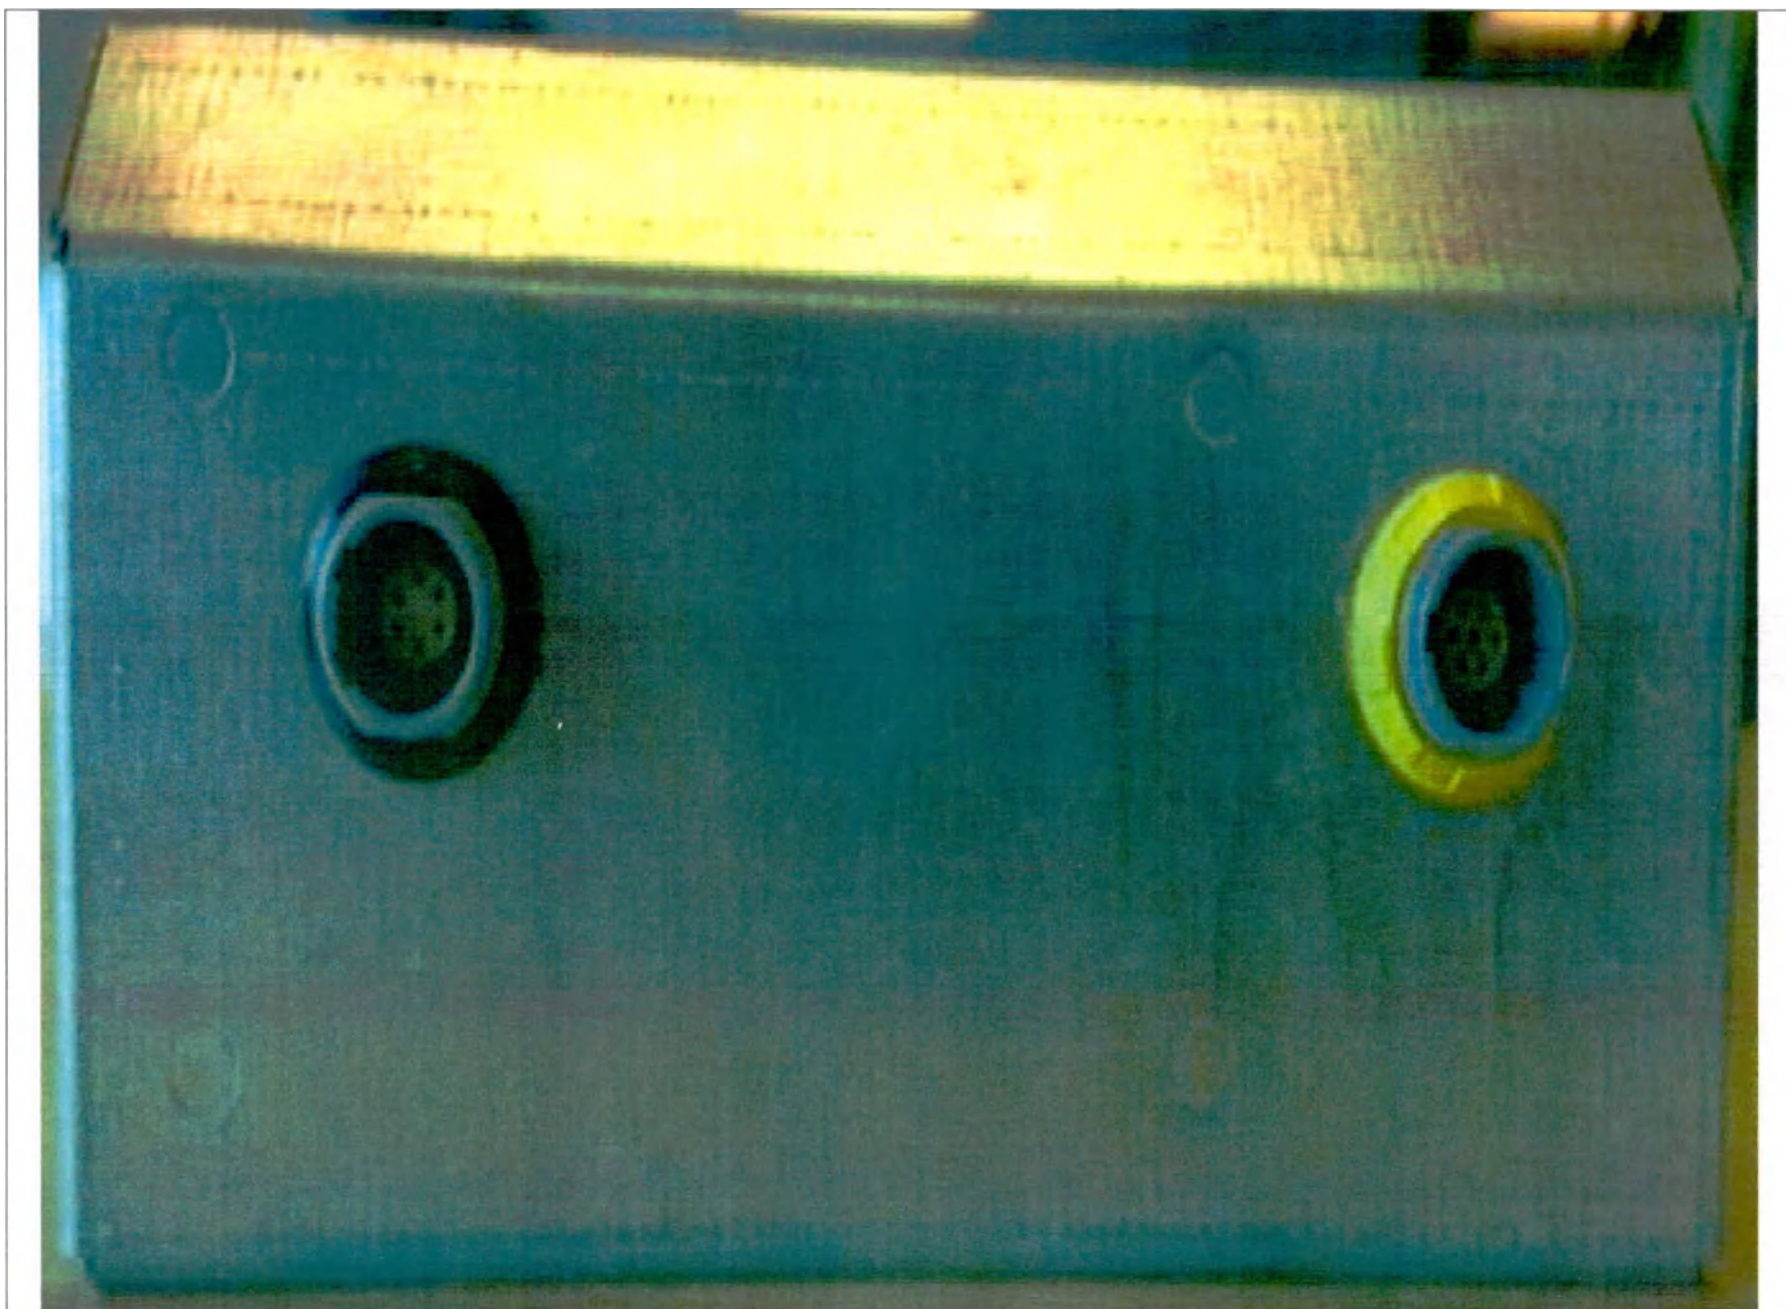


9. Лицензионный ключ для физиологического модуля с функцией ЭКГ.

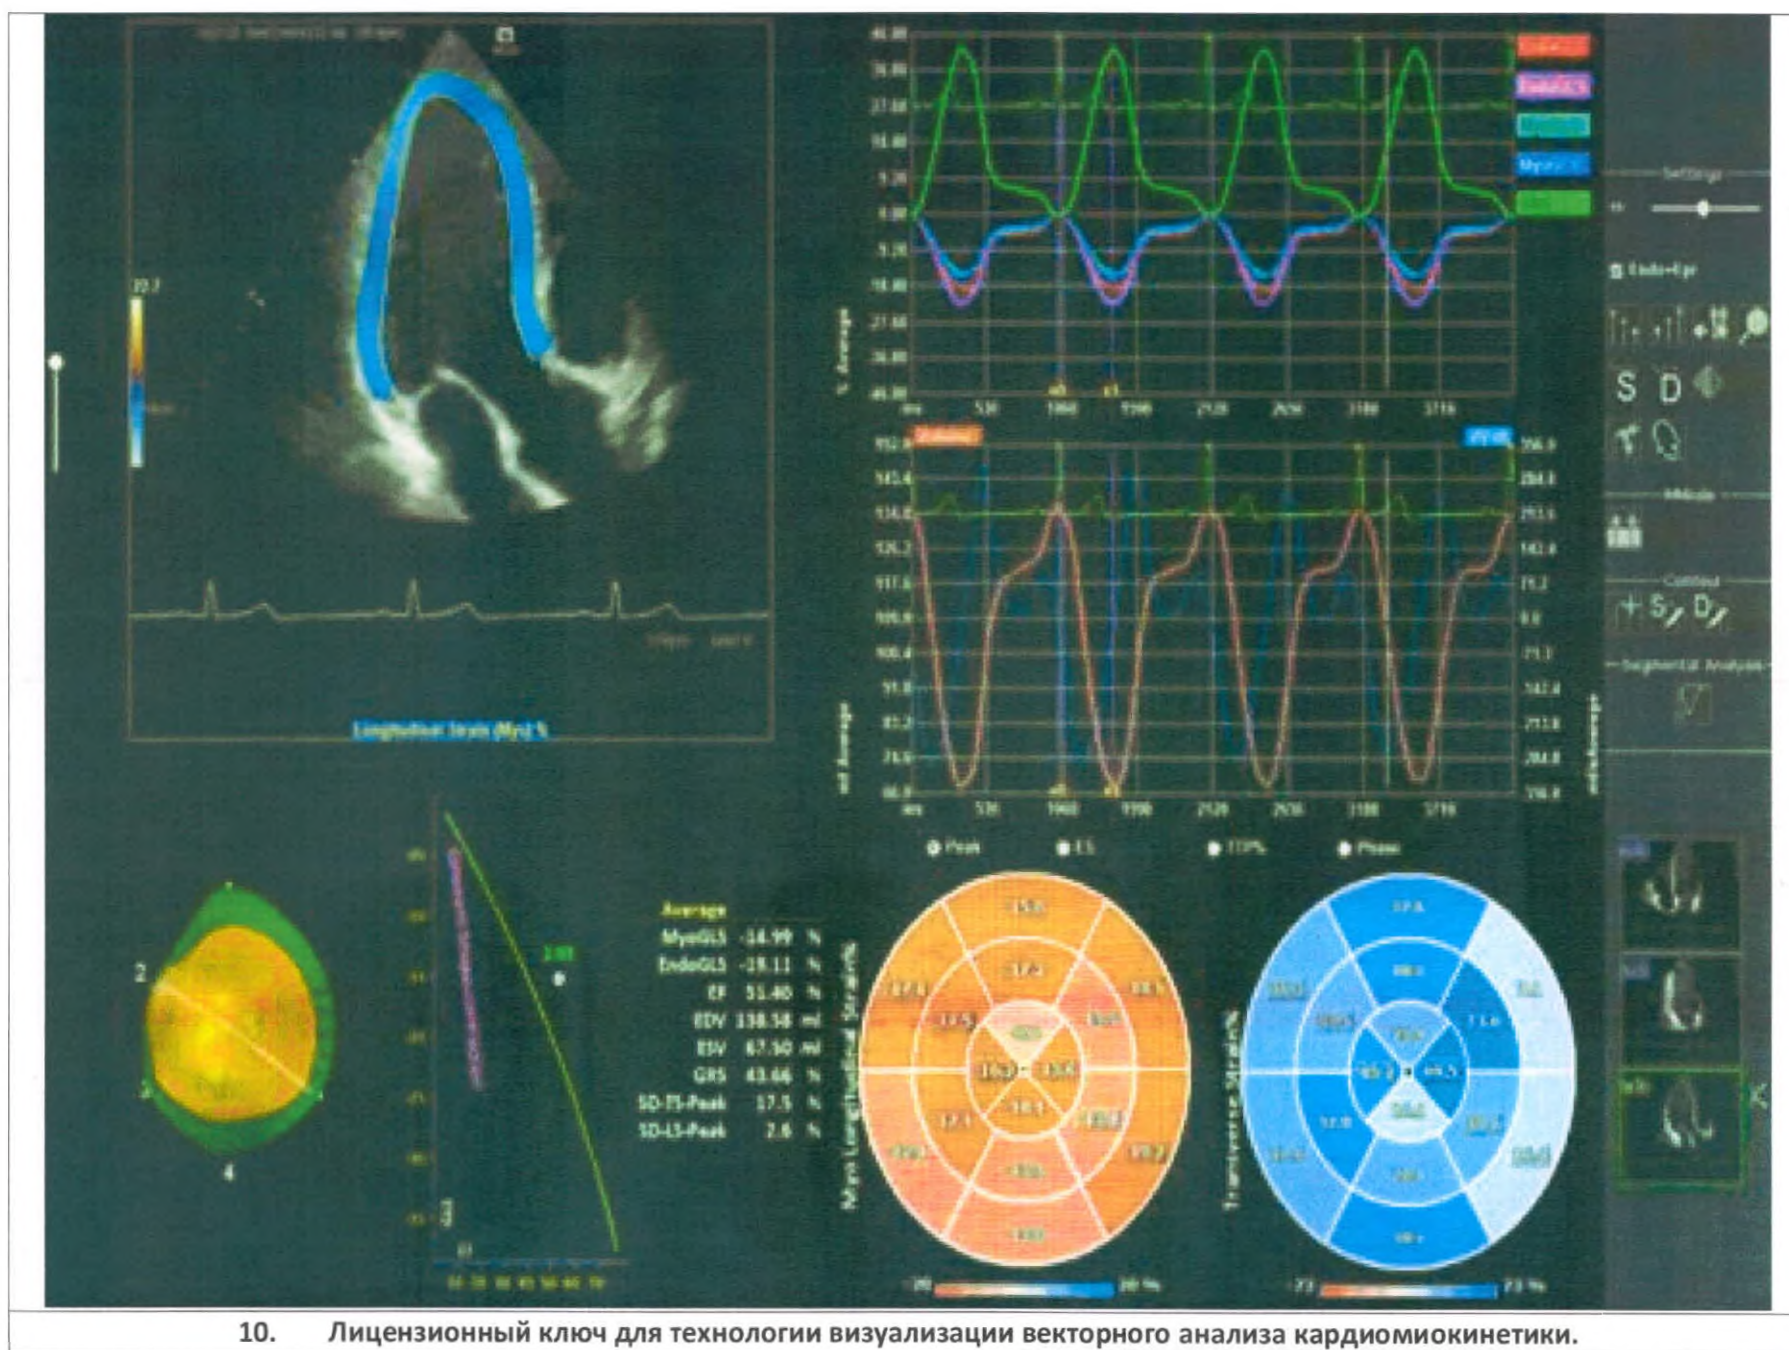


10. Лицензионный ключ для технологии визуализации векторного анализа кардиомиокинетики.

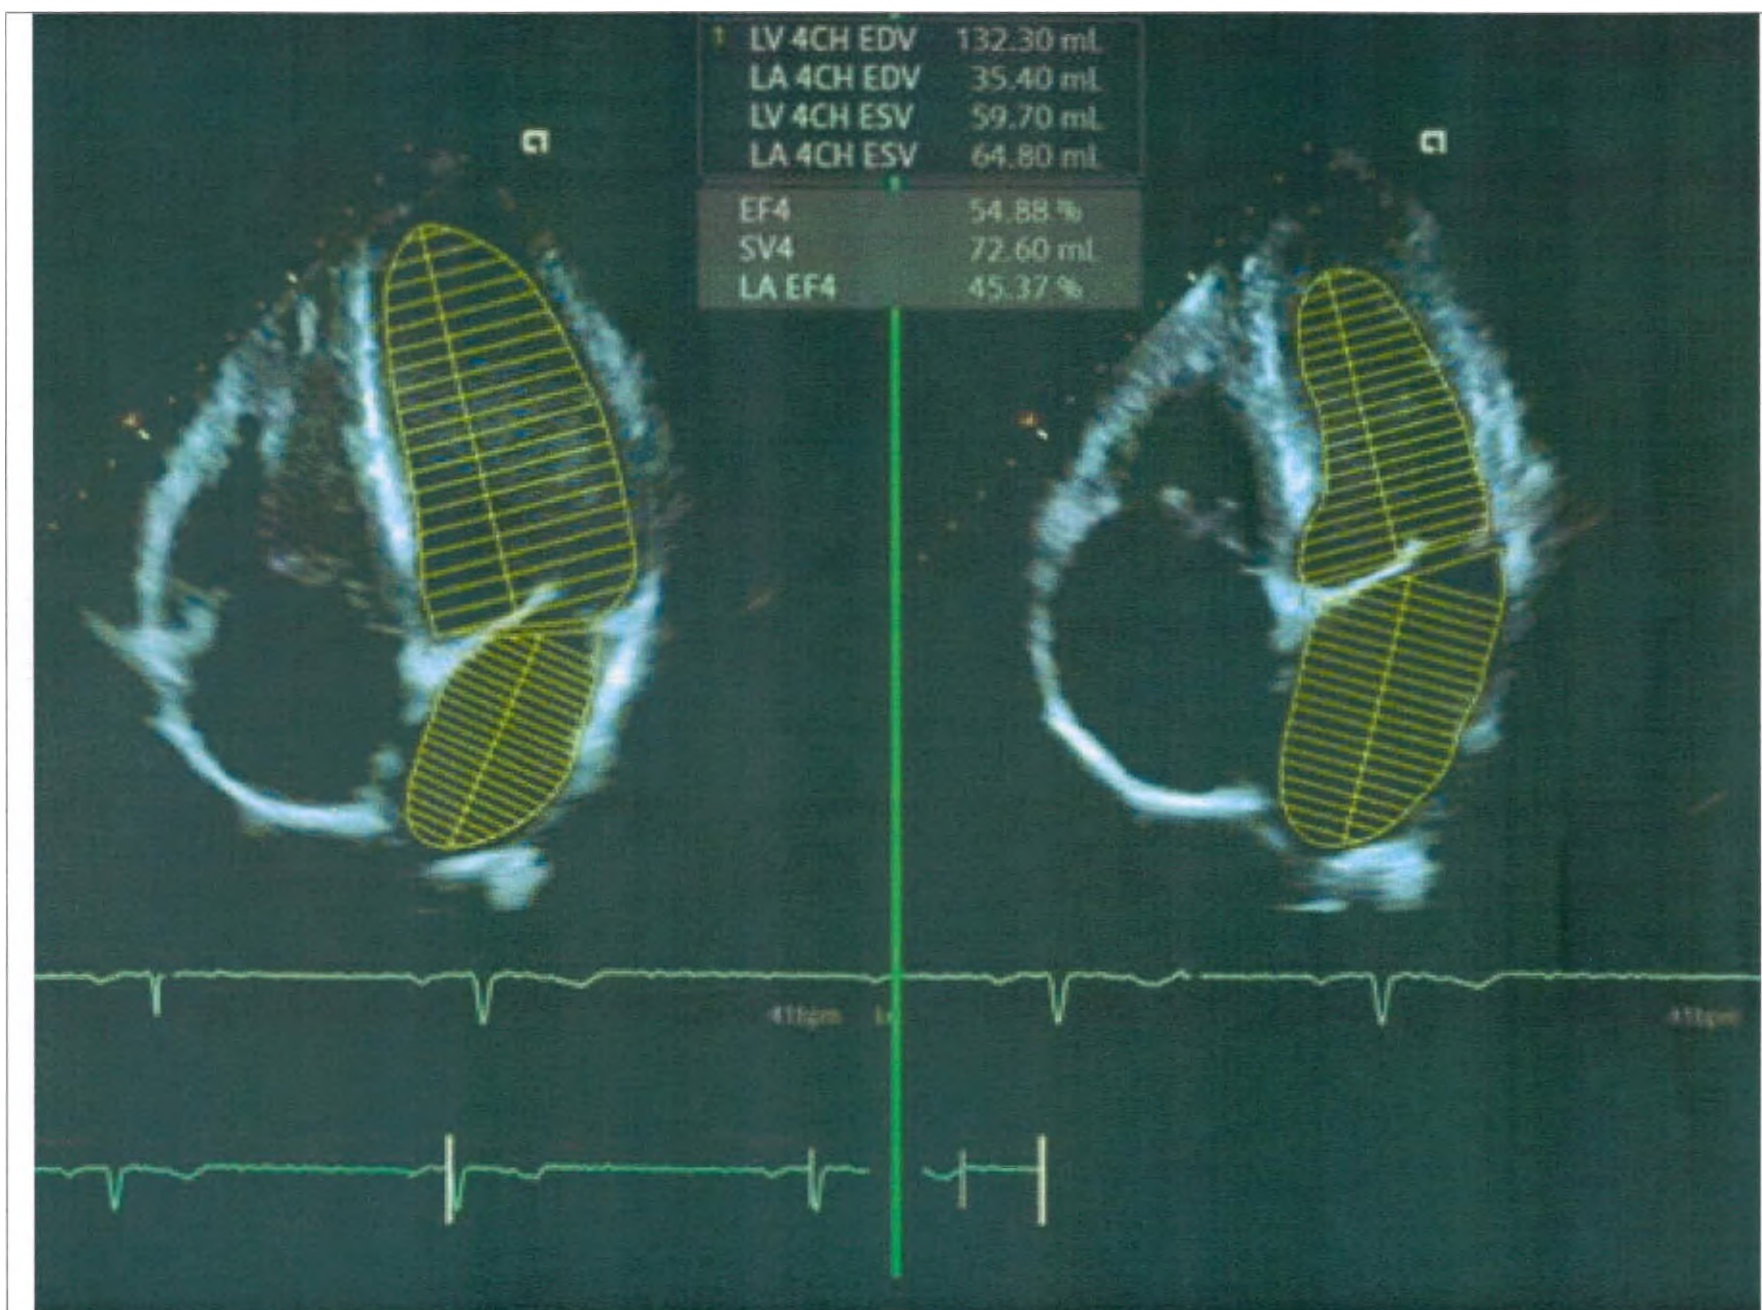

11. Лицензионный ключ для технологии автоматического исследования левых отделов сердца.

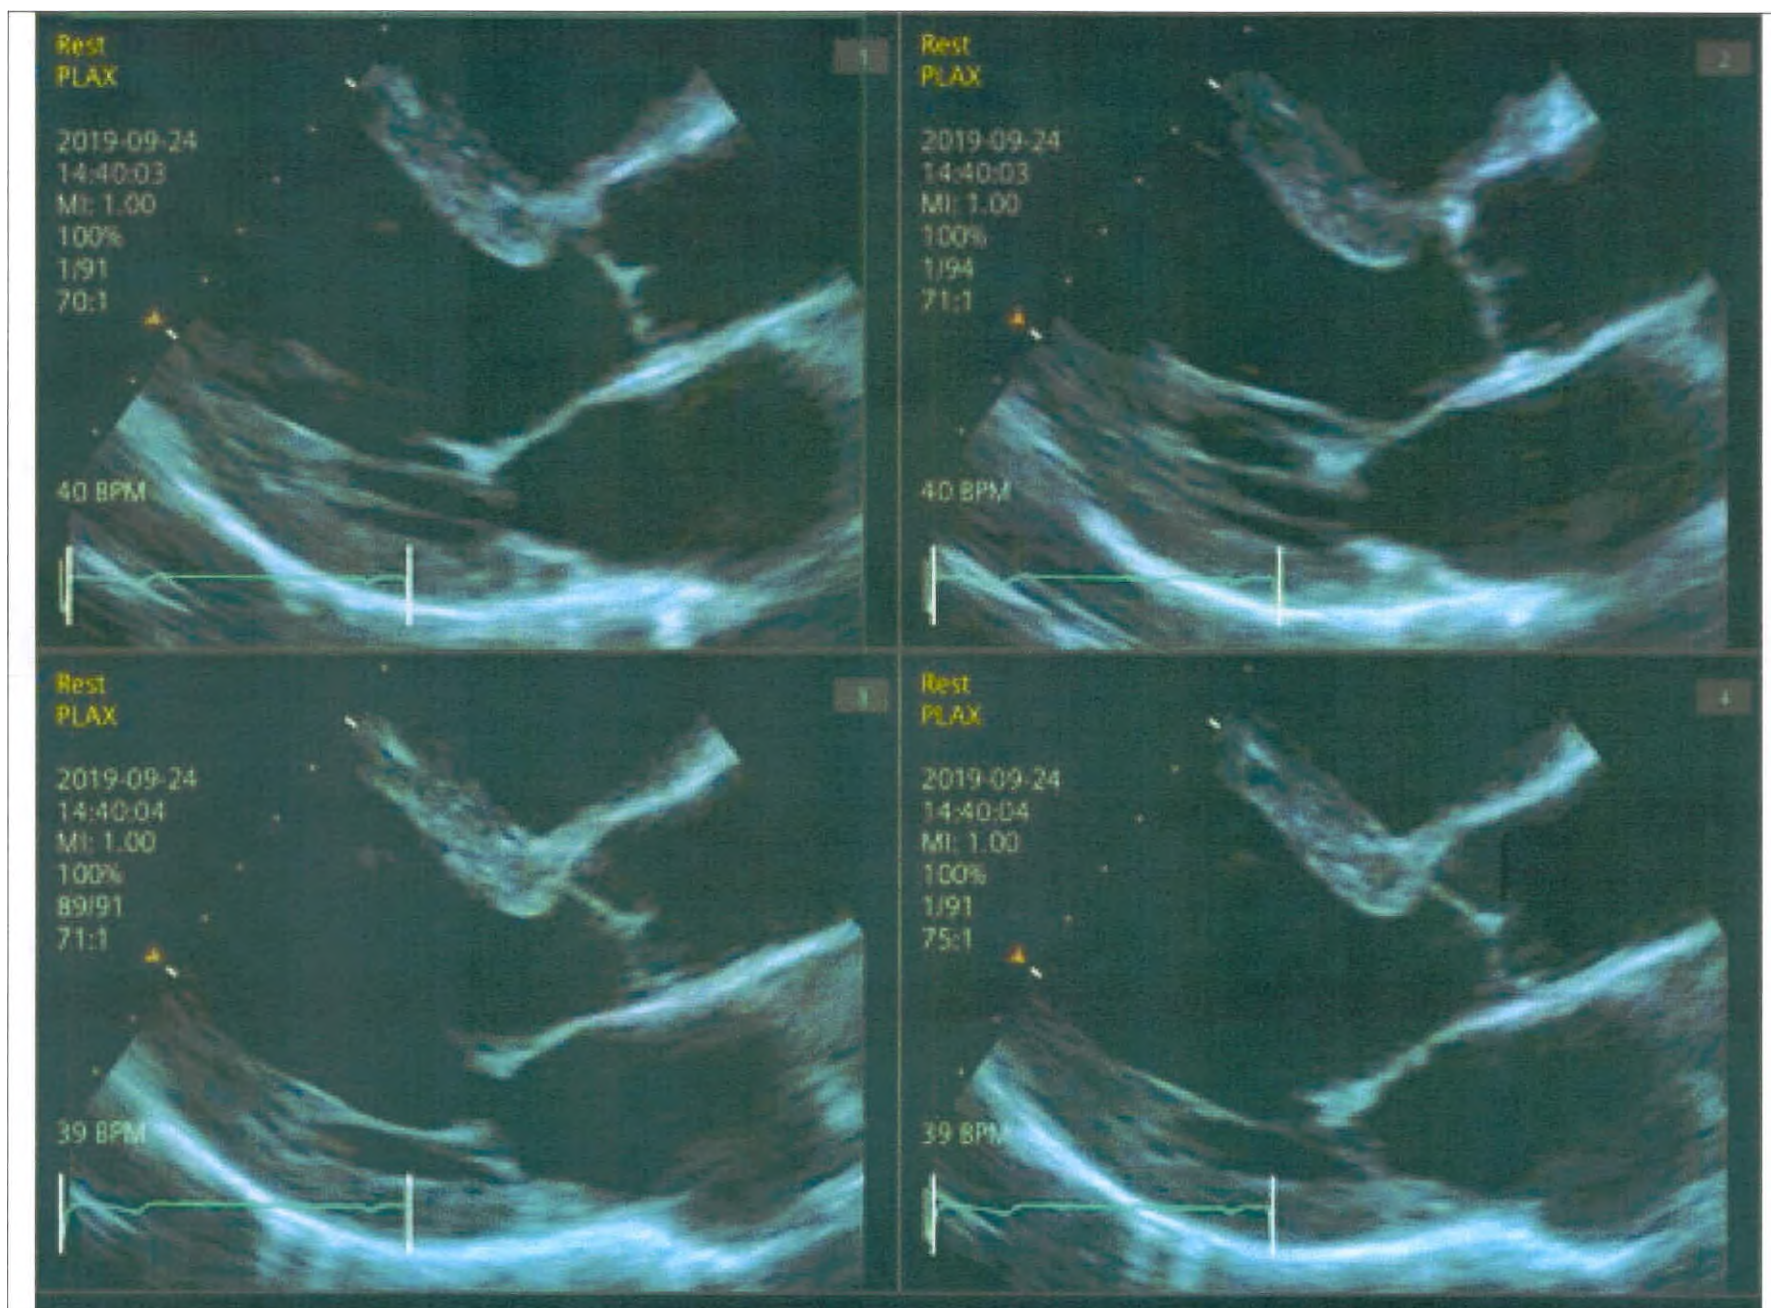


12. Лицензионный ключ для технологии стресс-эхокардиографии.

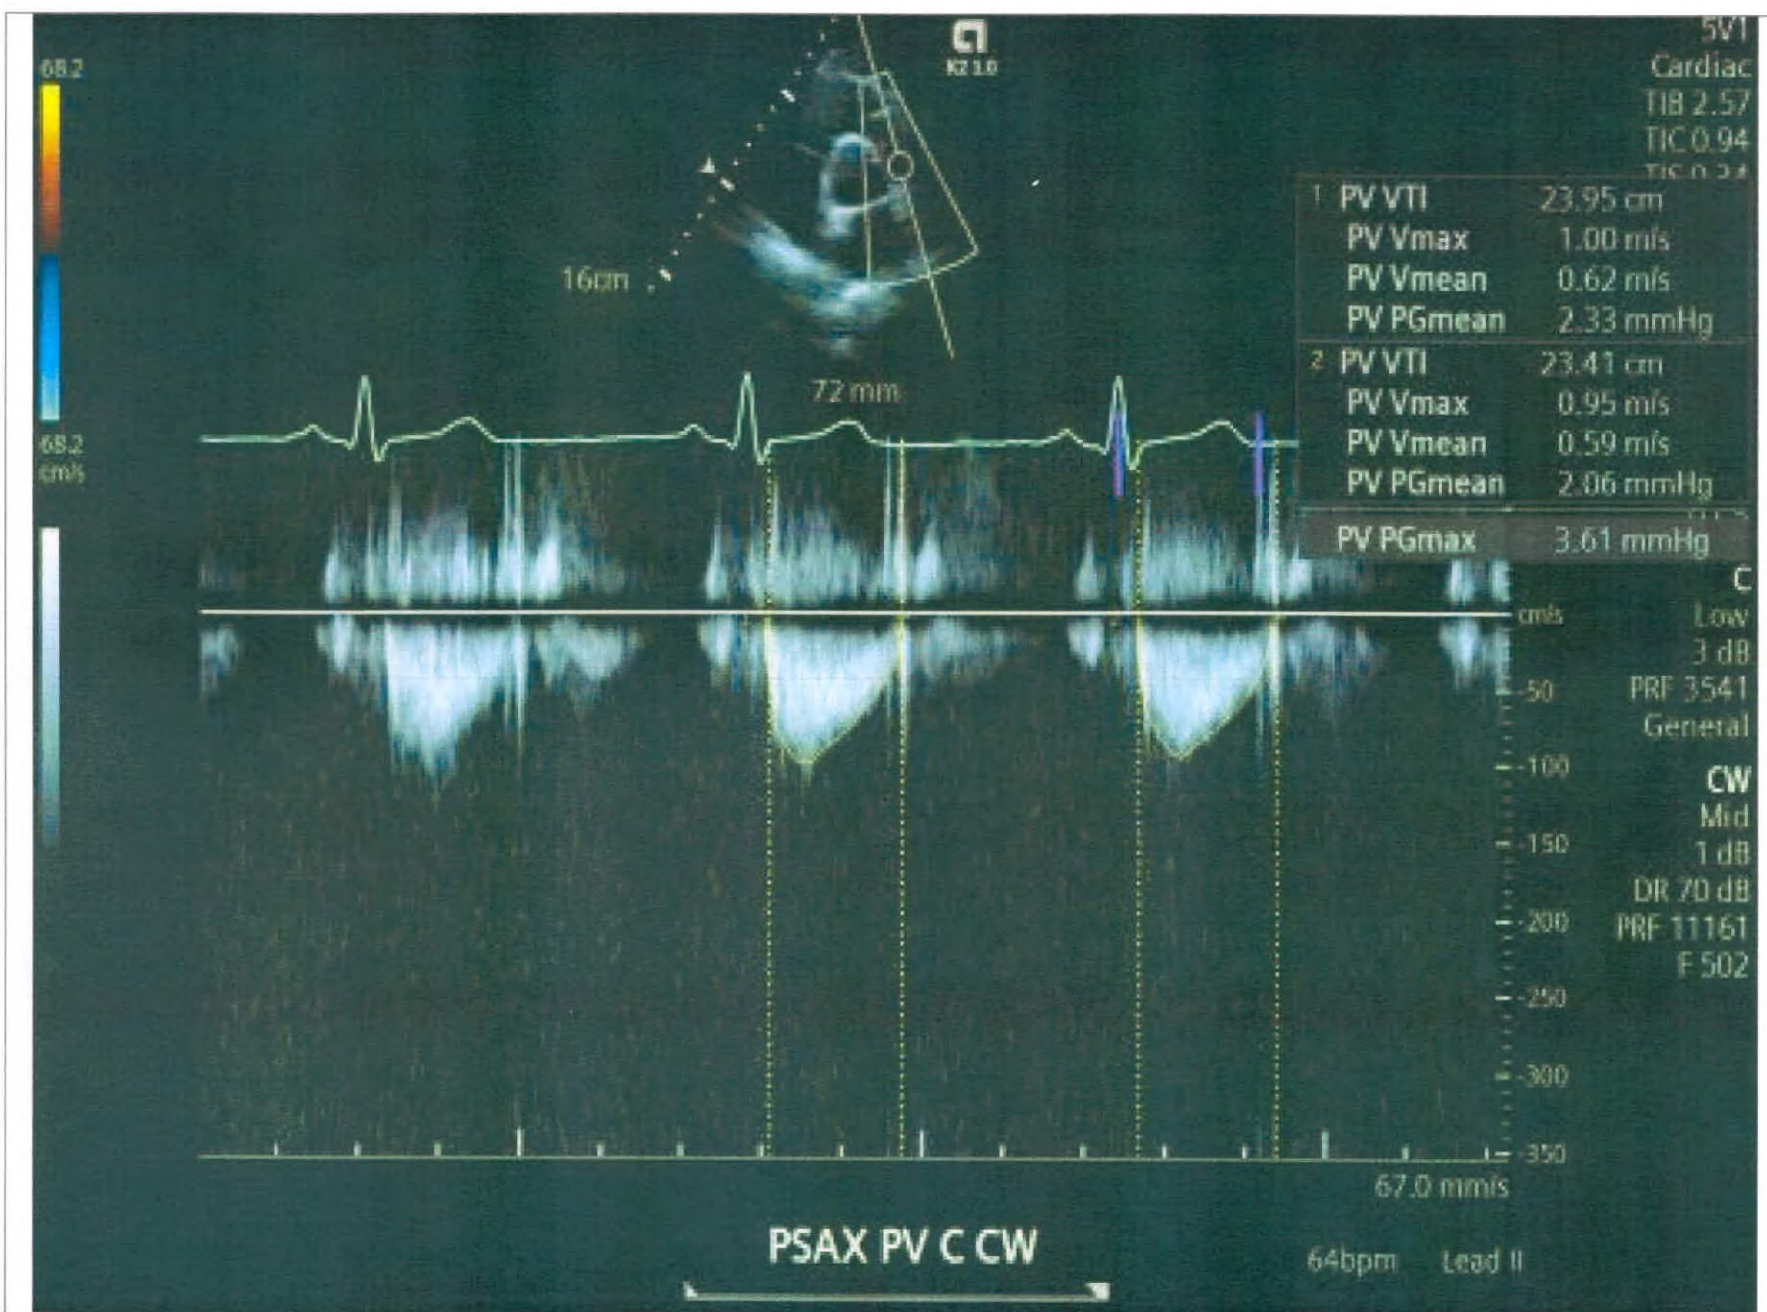

13. Лицензионный ключ для технологии автоматизации процесса измерений в 2D-, M- и доплеровских режимах.



14. Лицензионный ключ для технологии контрастирования левого желудочка с низким механическим индексом.

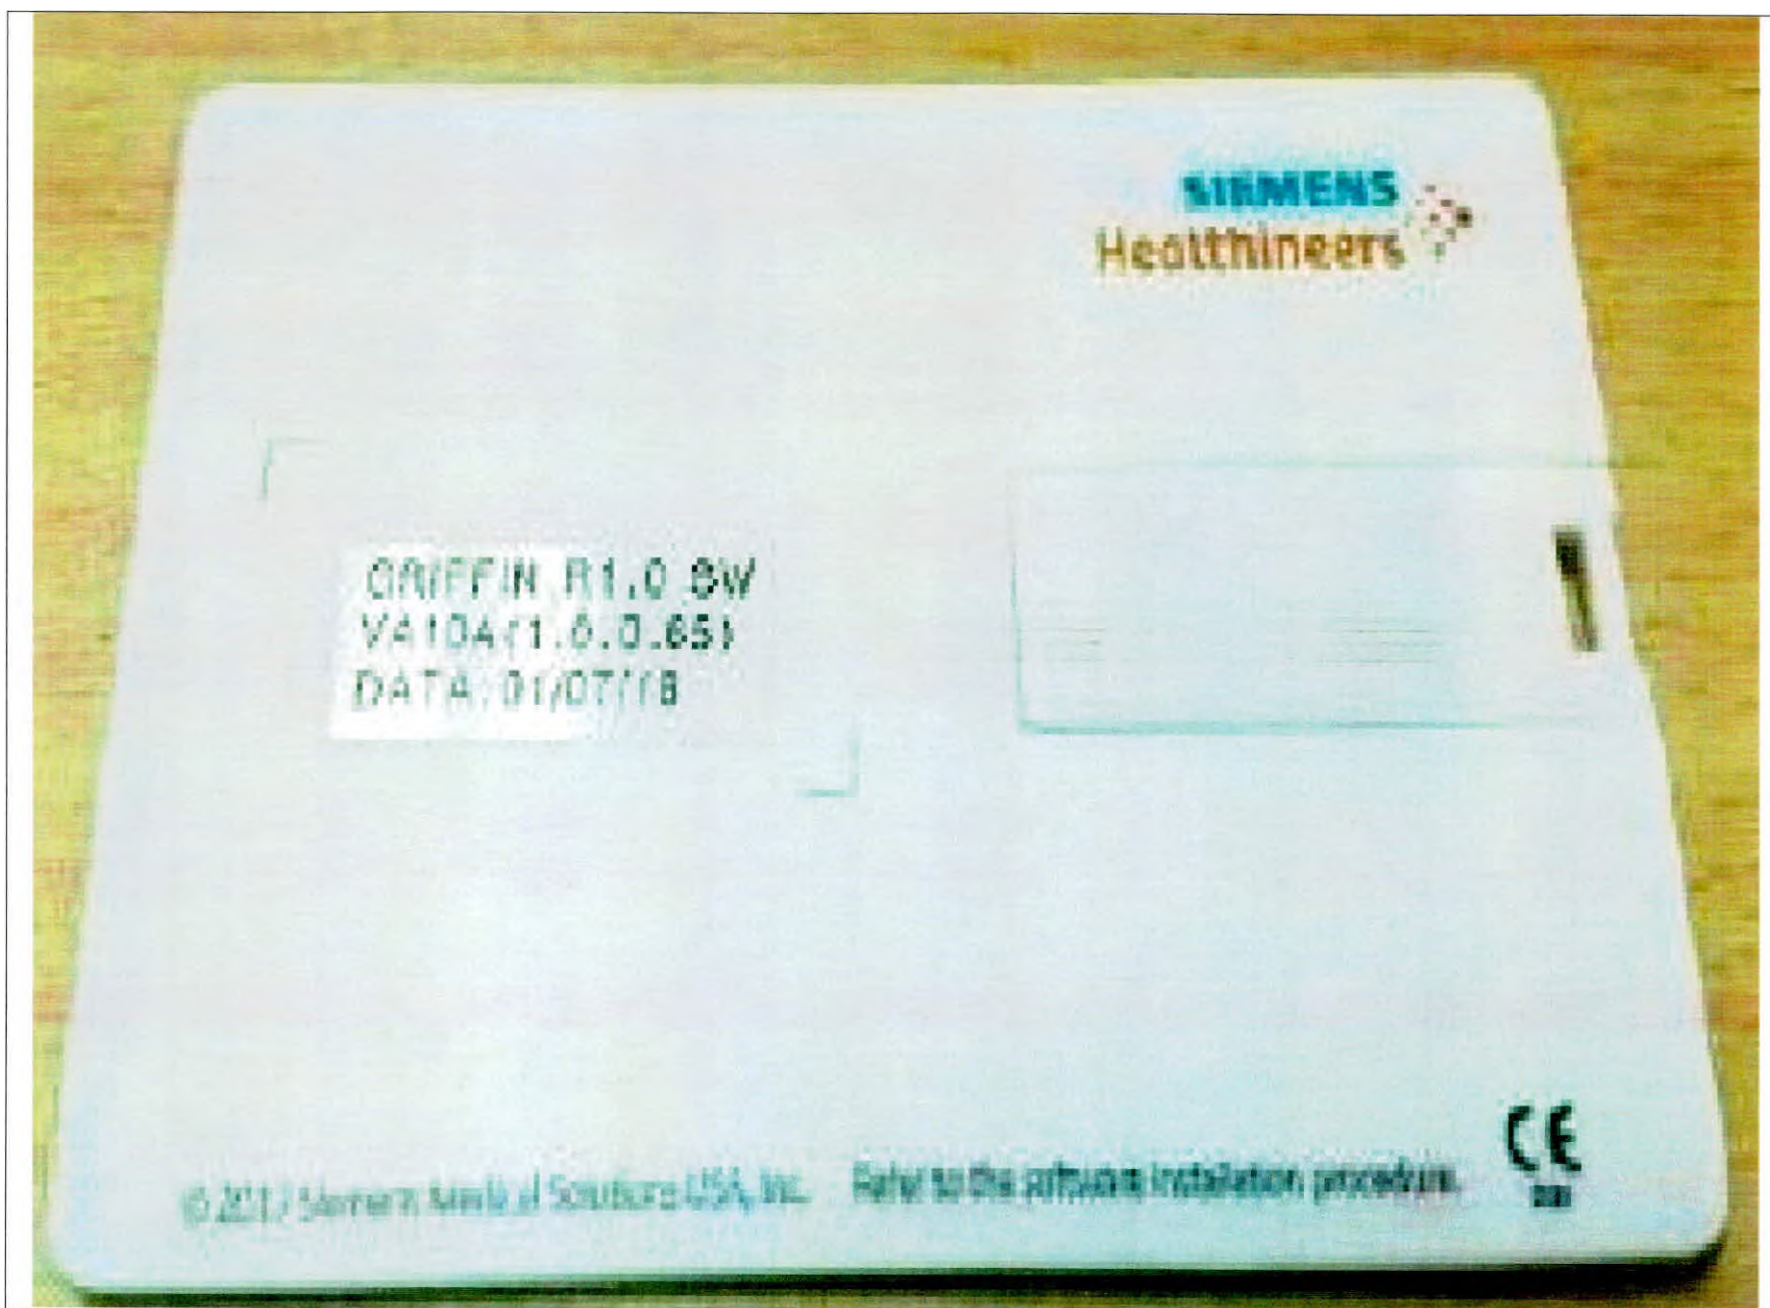

16. Лицензионный ключ для технологии антивирусной защиты данных пациента.




17. Кабель с адаптером для проведения стресс-эхокардиографии - 1 шт., но не более 5 шт. (при необходимости).




18.1 Устройства для удаленного сервисного обслуживания




18.2 Устройства для удаленного сервисного обслуживания

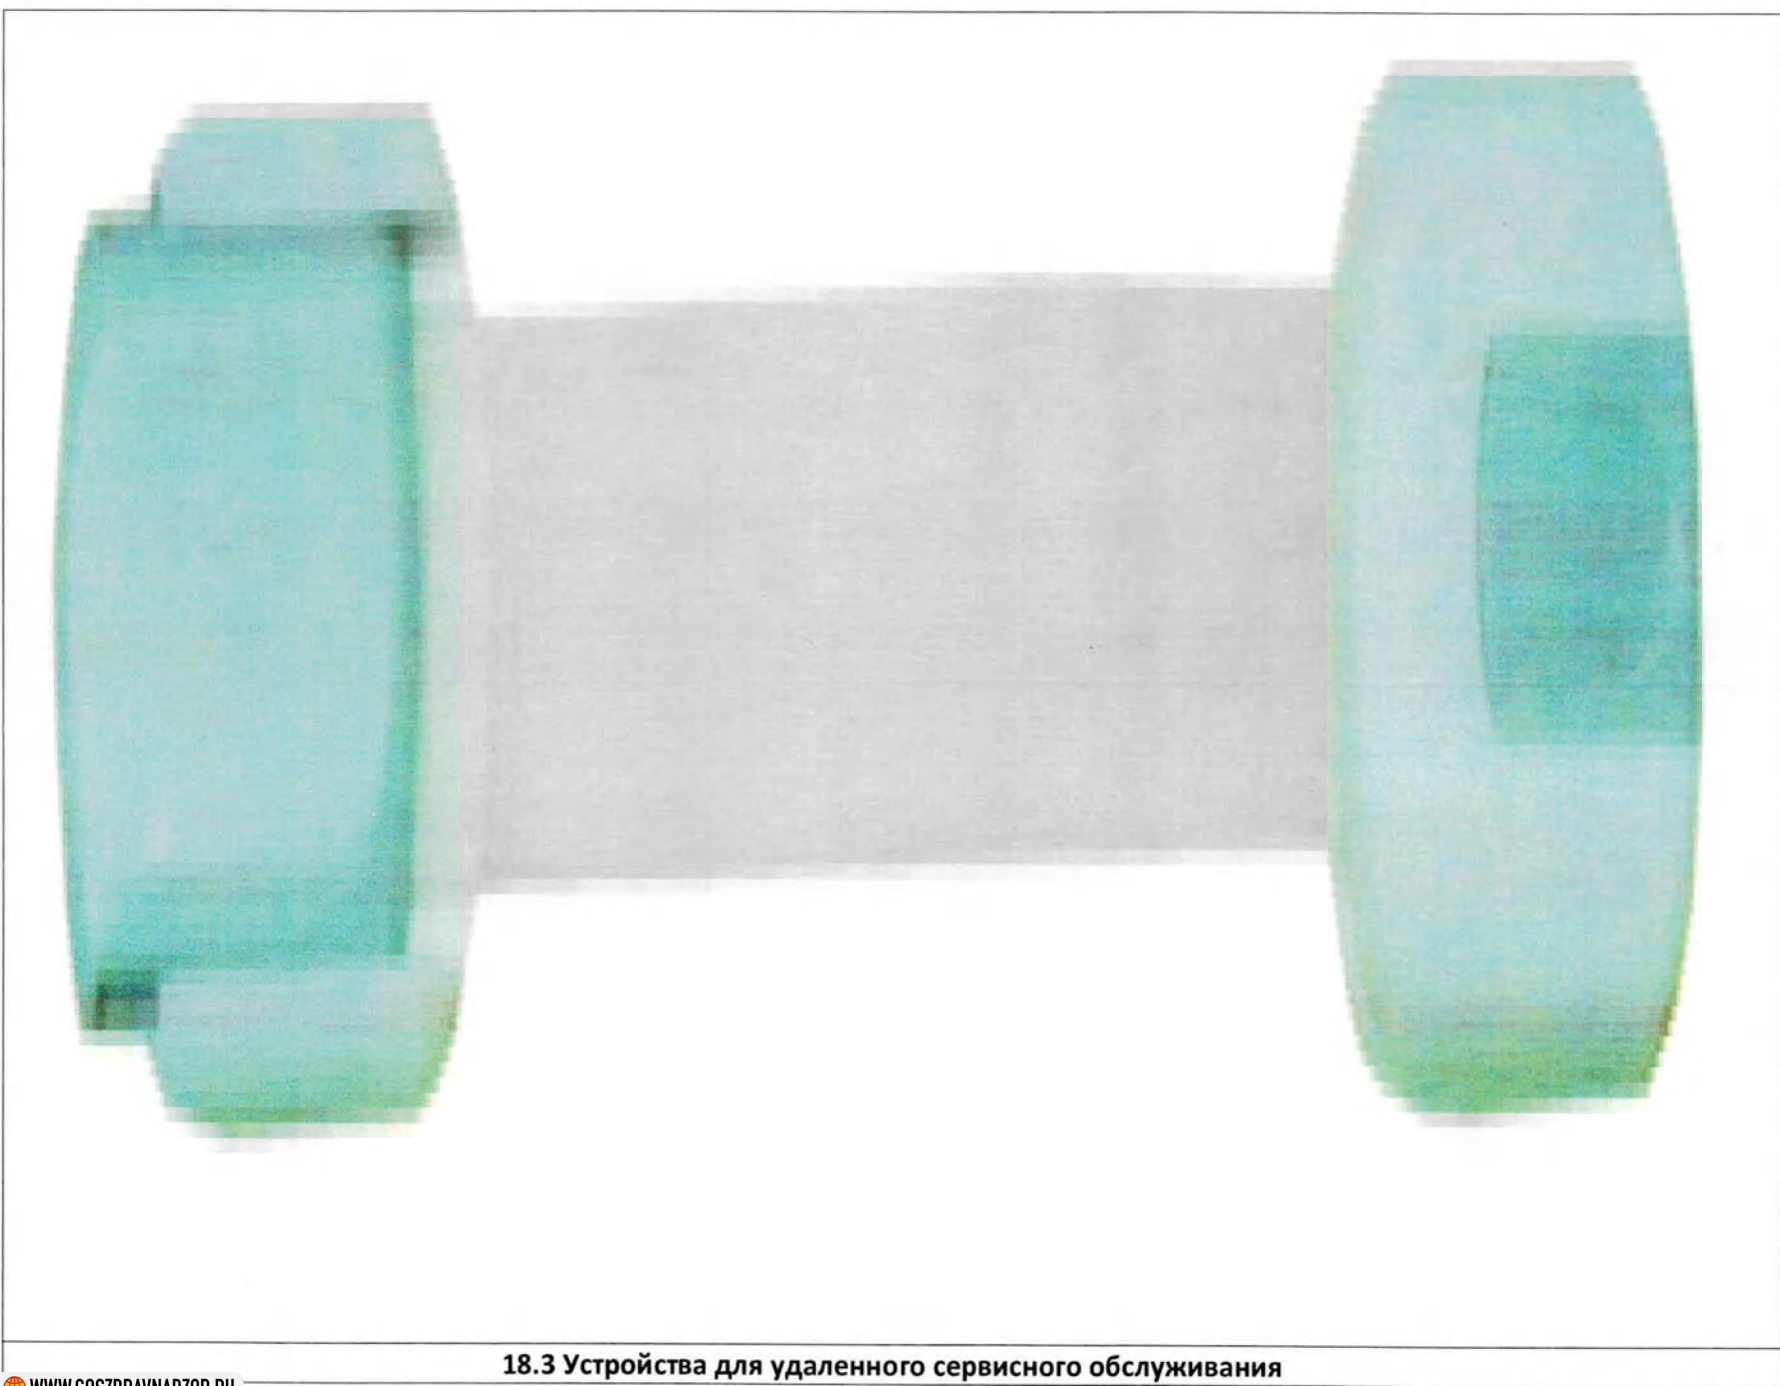


18.3 Устройства для удаленного сервисного обслуживания

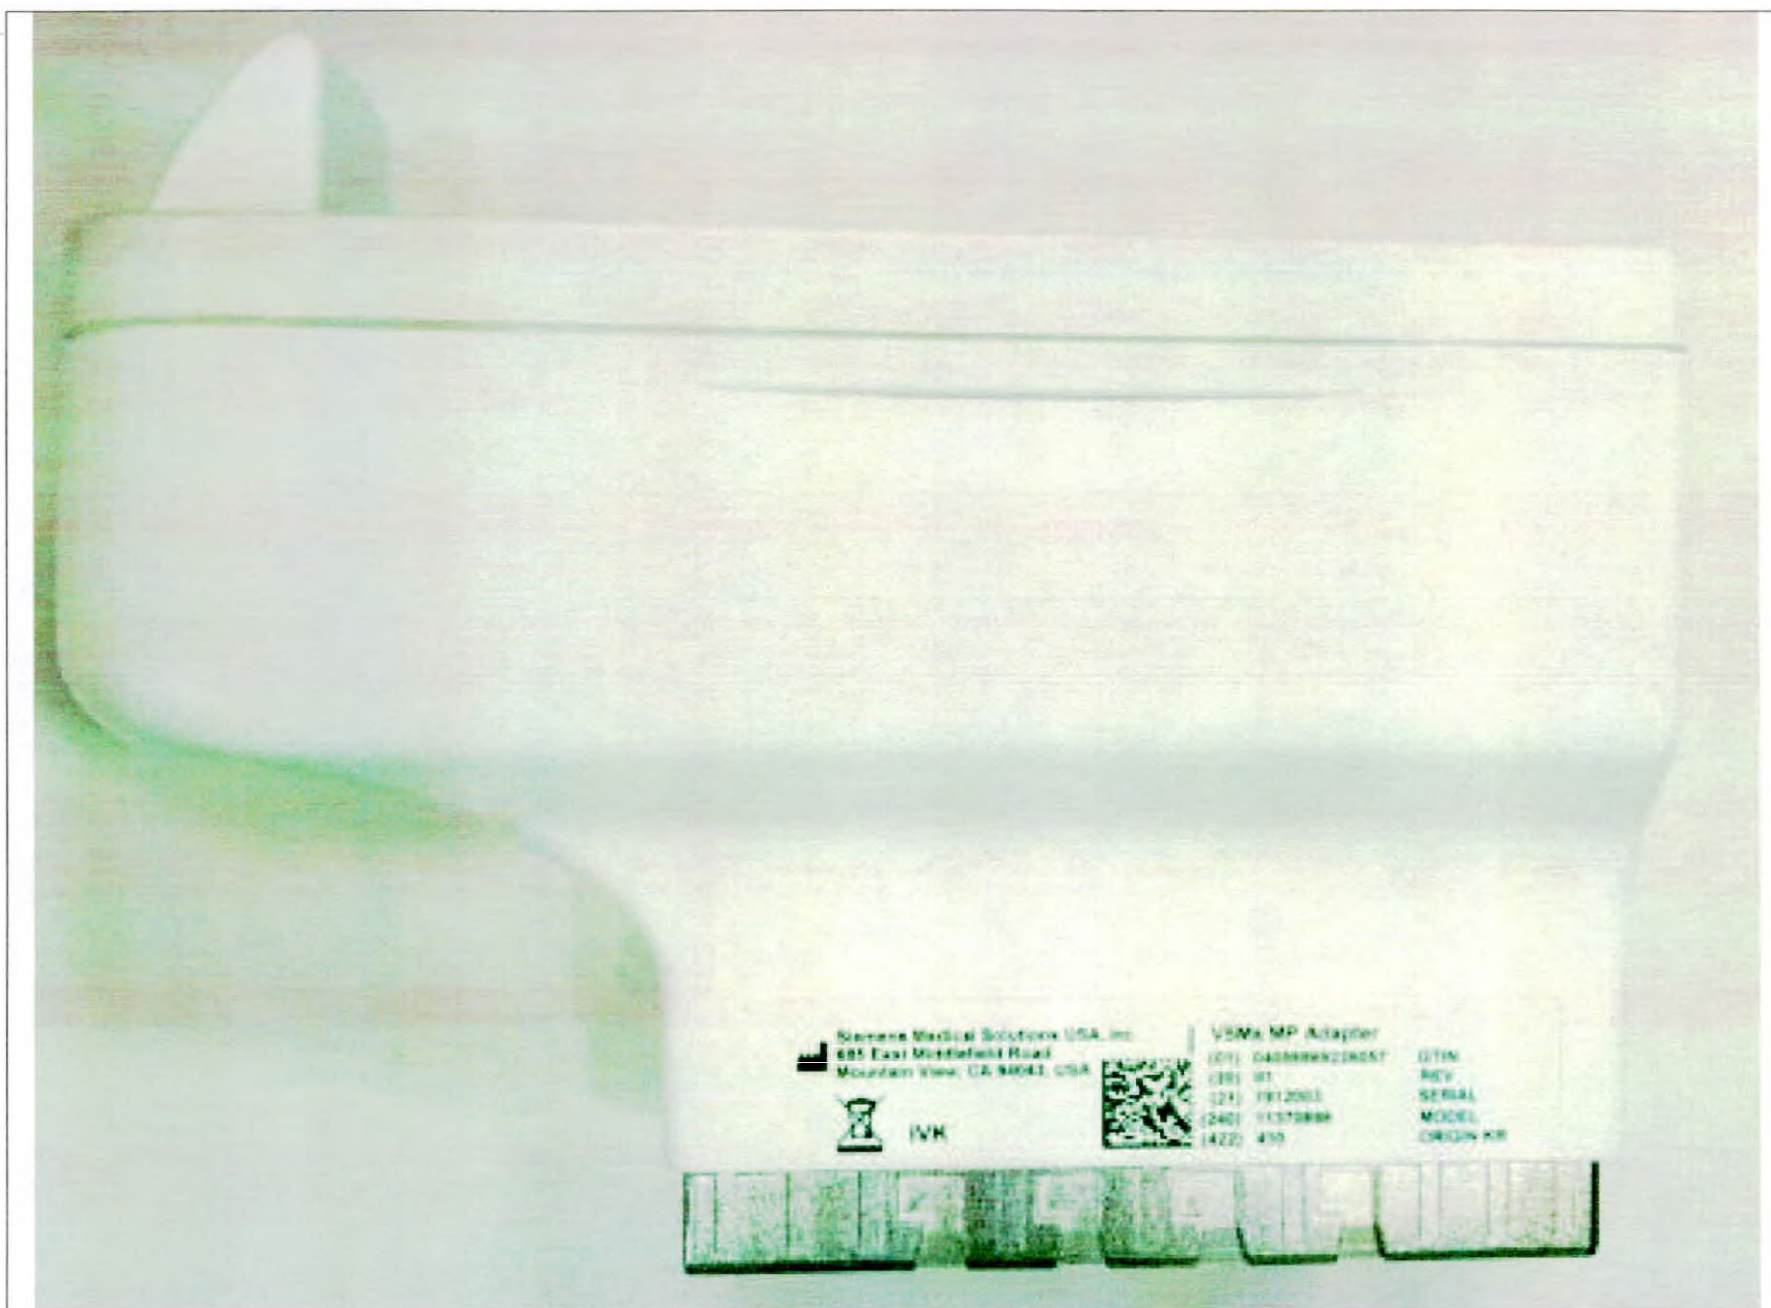

19. Адаптер для подключения чреспищеводного датчика

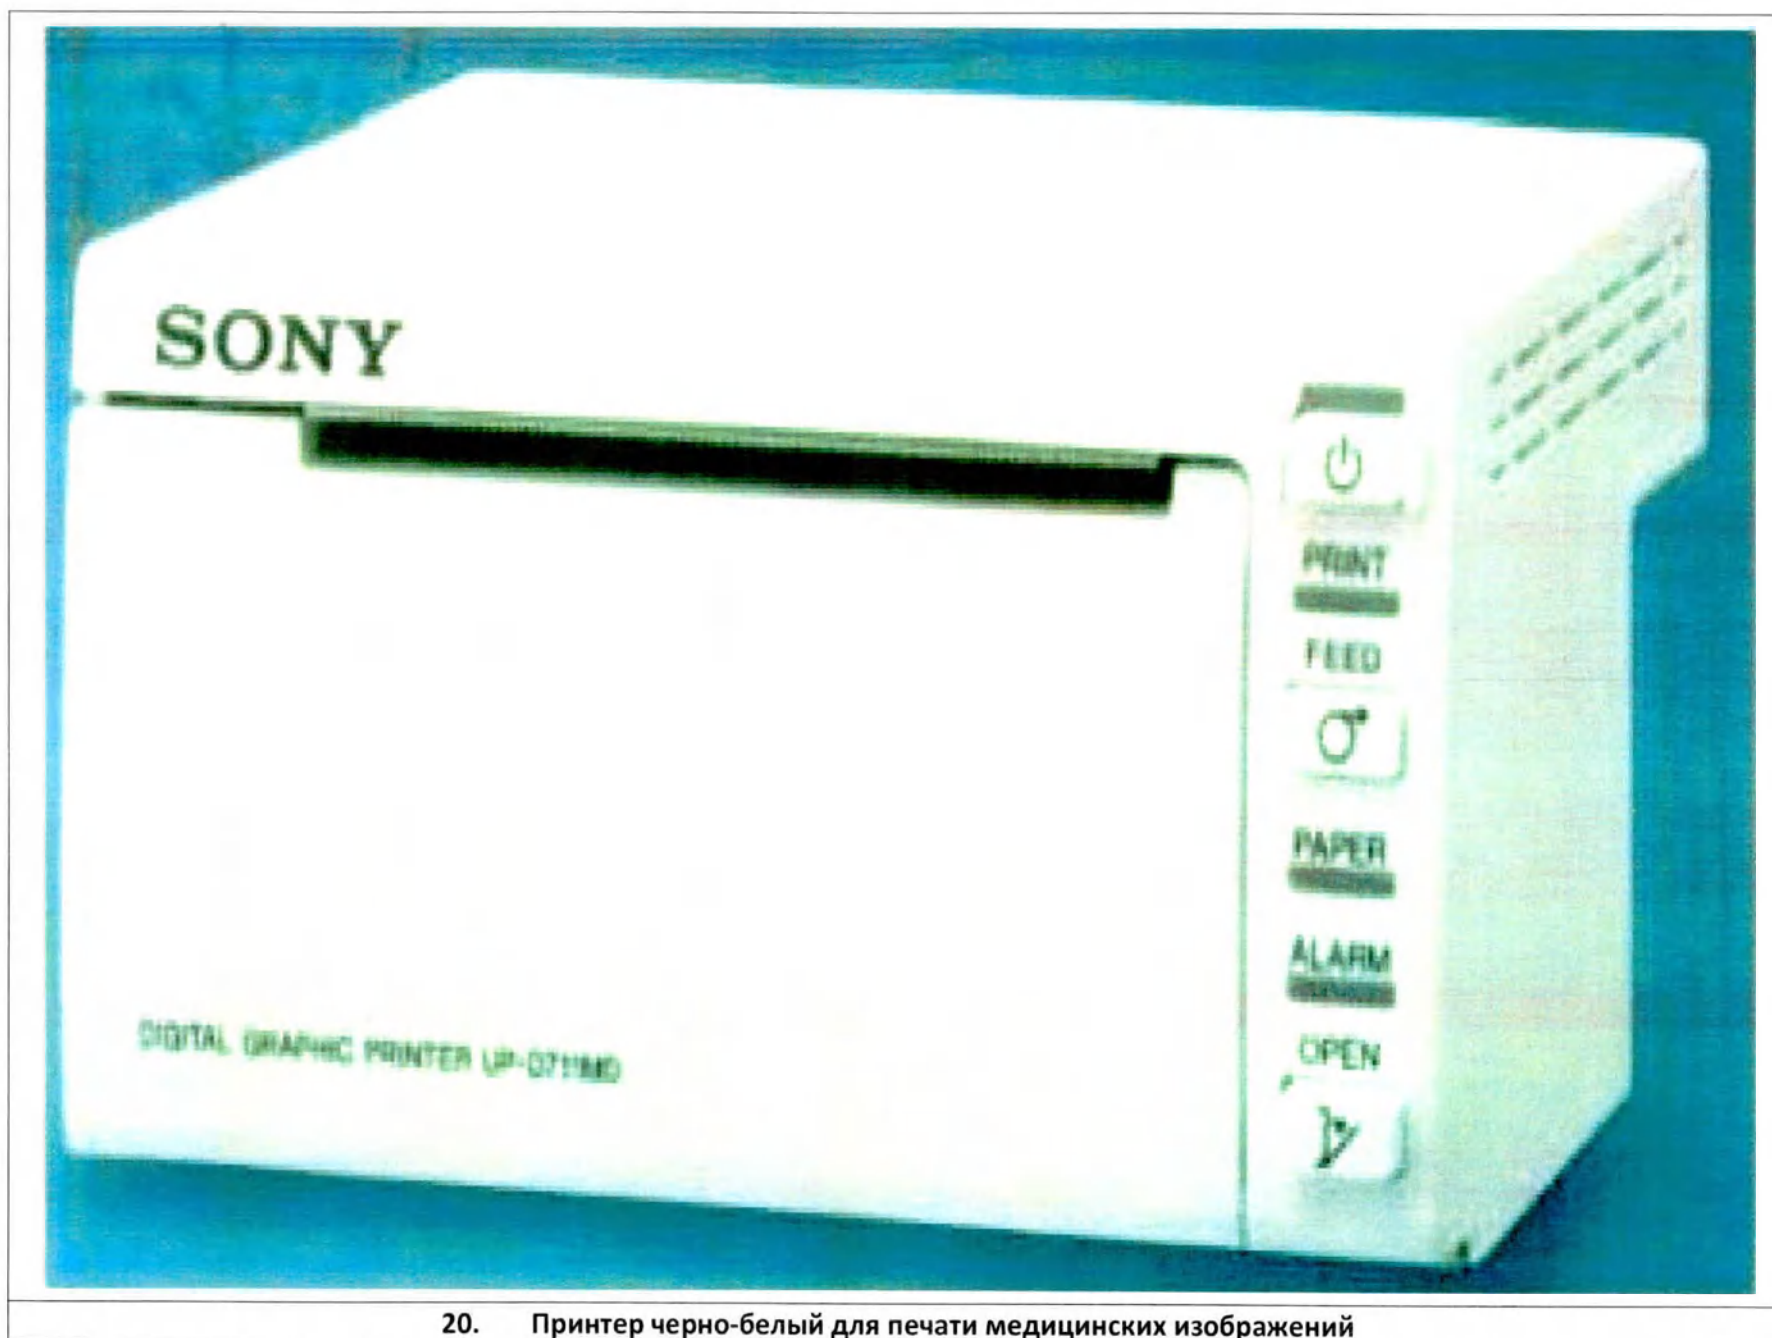

20. Принтер черно-белый для печати медицинских изображений

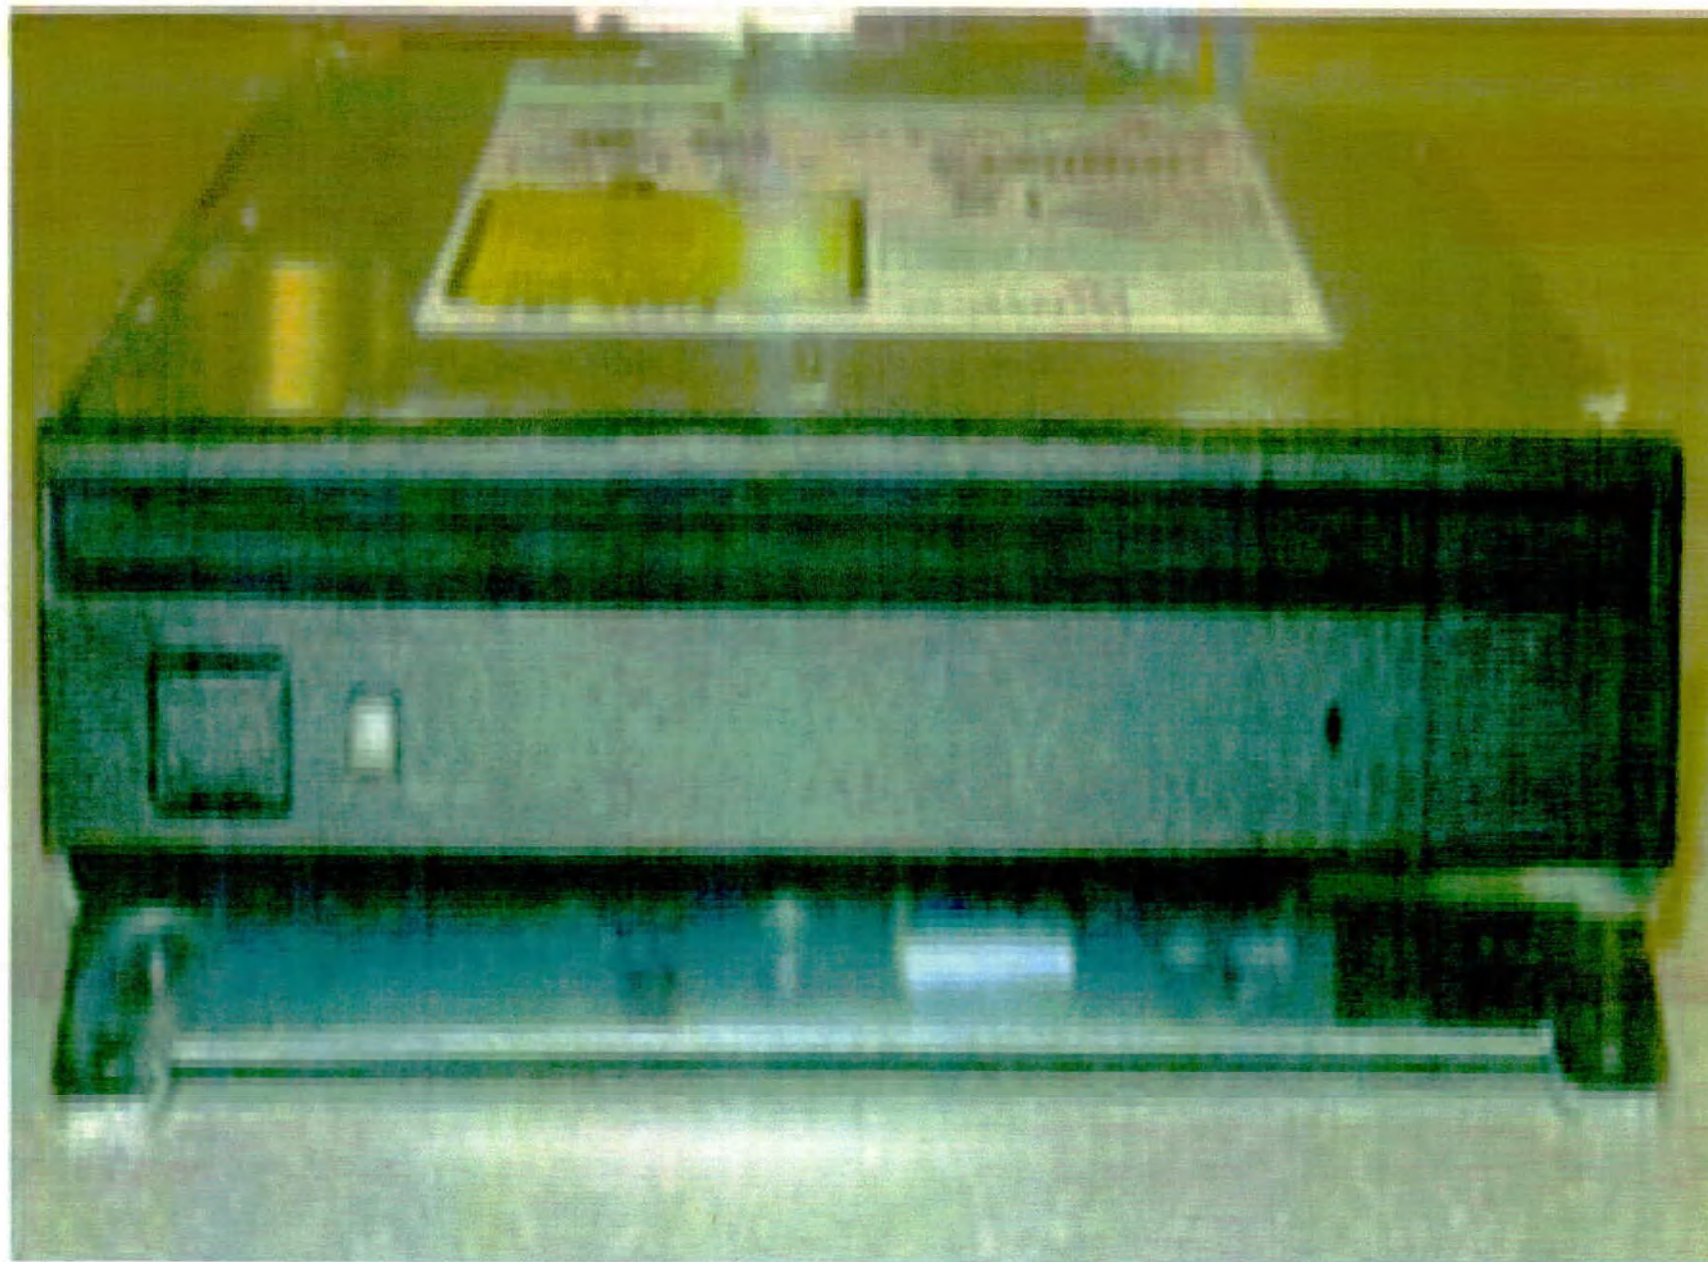

21. Устройство цифровой видеозаписи




22. Кожух для модуля физиологического и/или принтера




23. Держатели для датчиков



24. Защитная накладка для панели управления

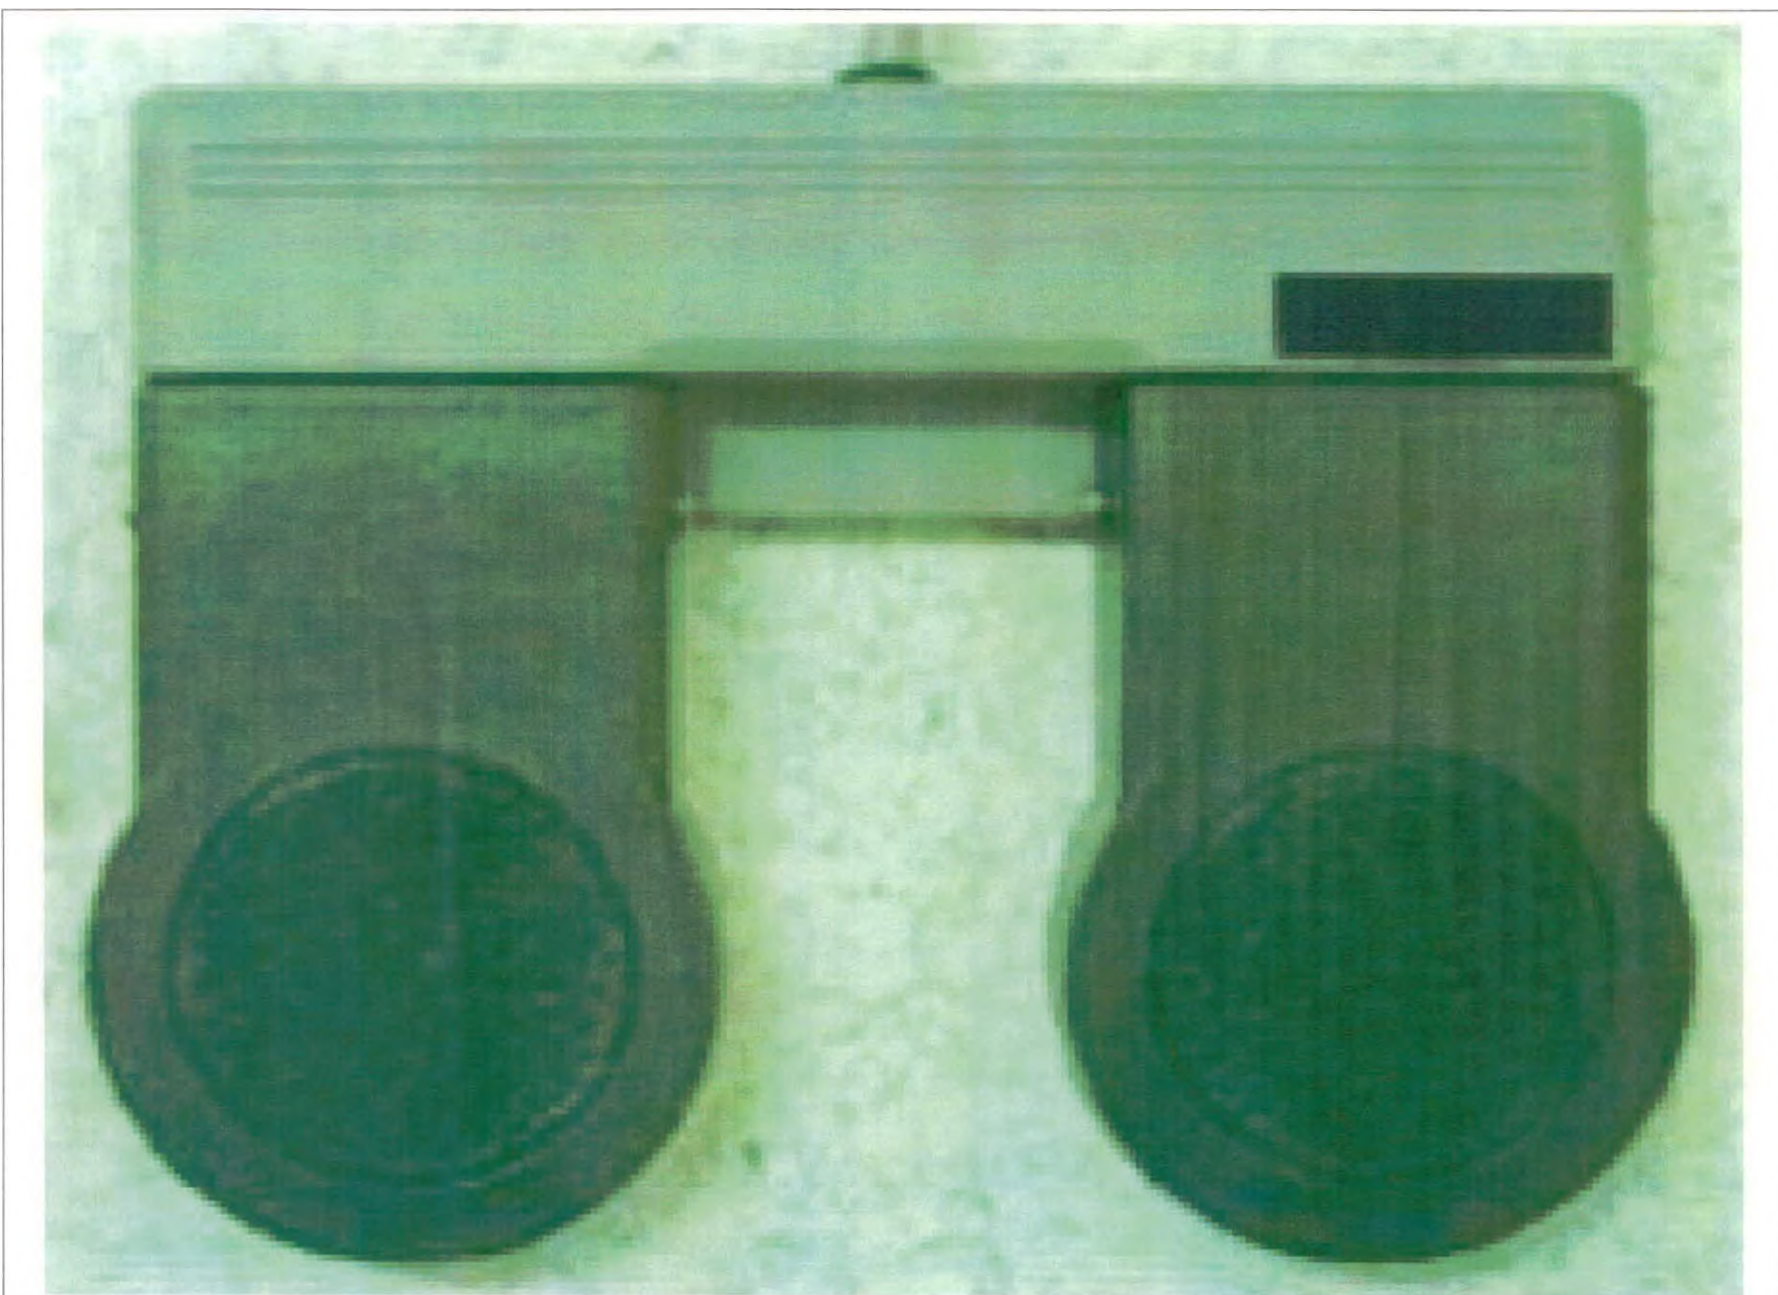


25. Ножной переключатель

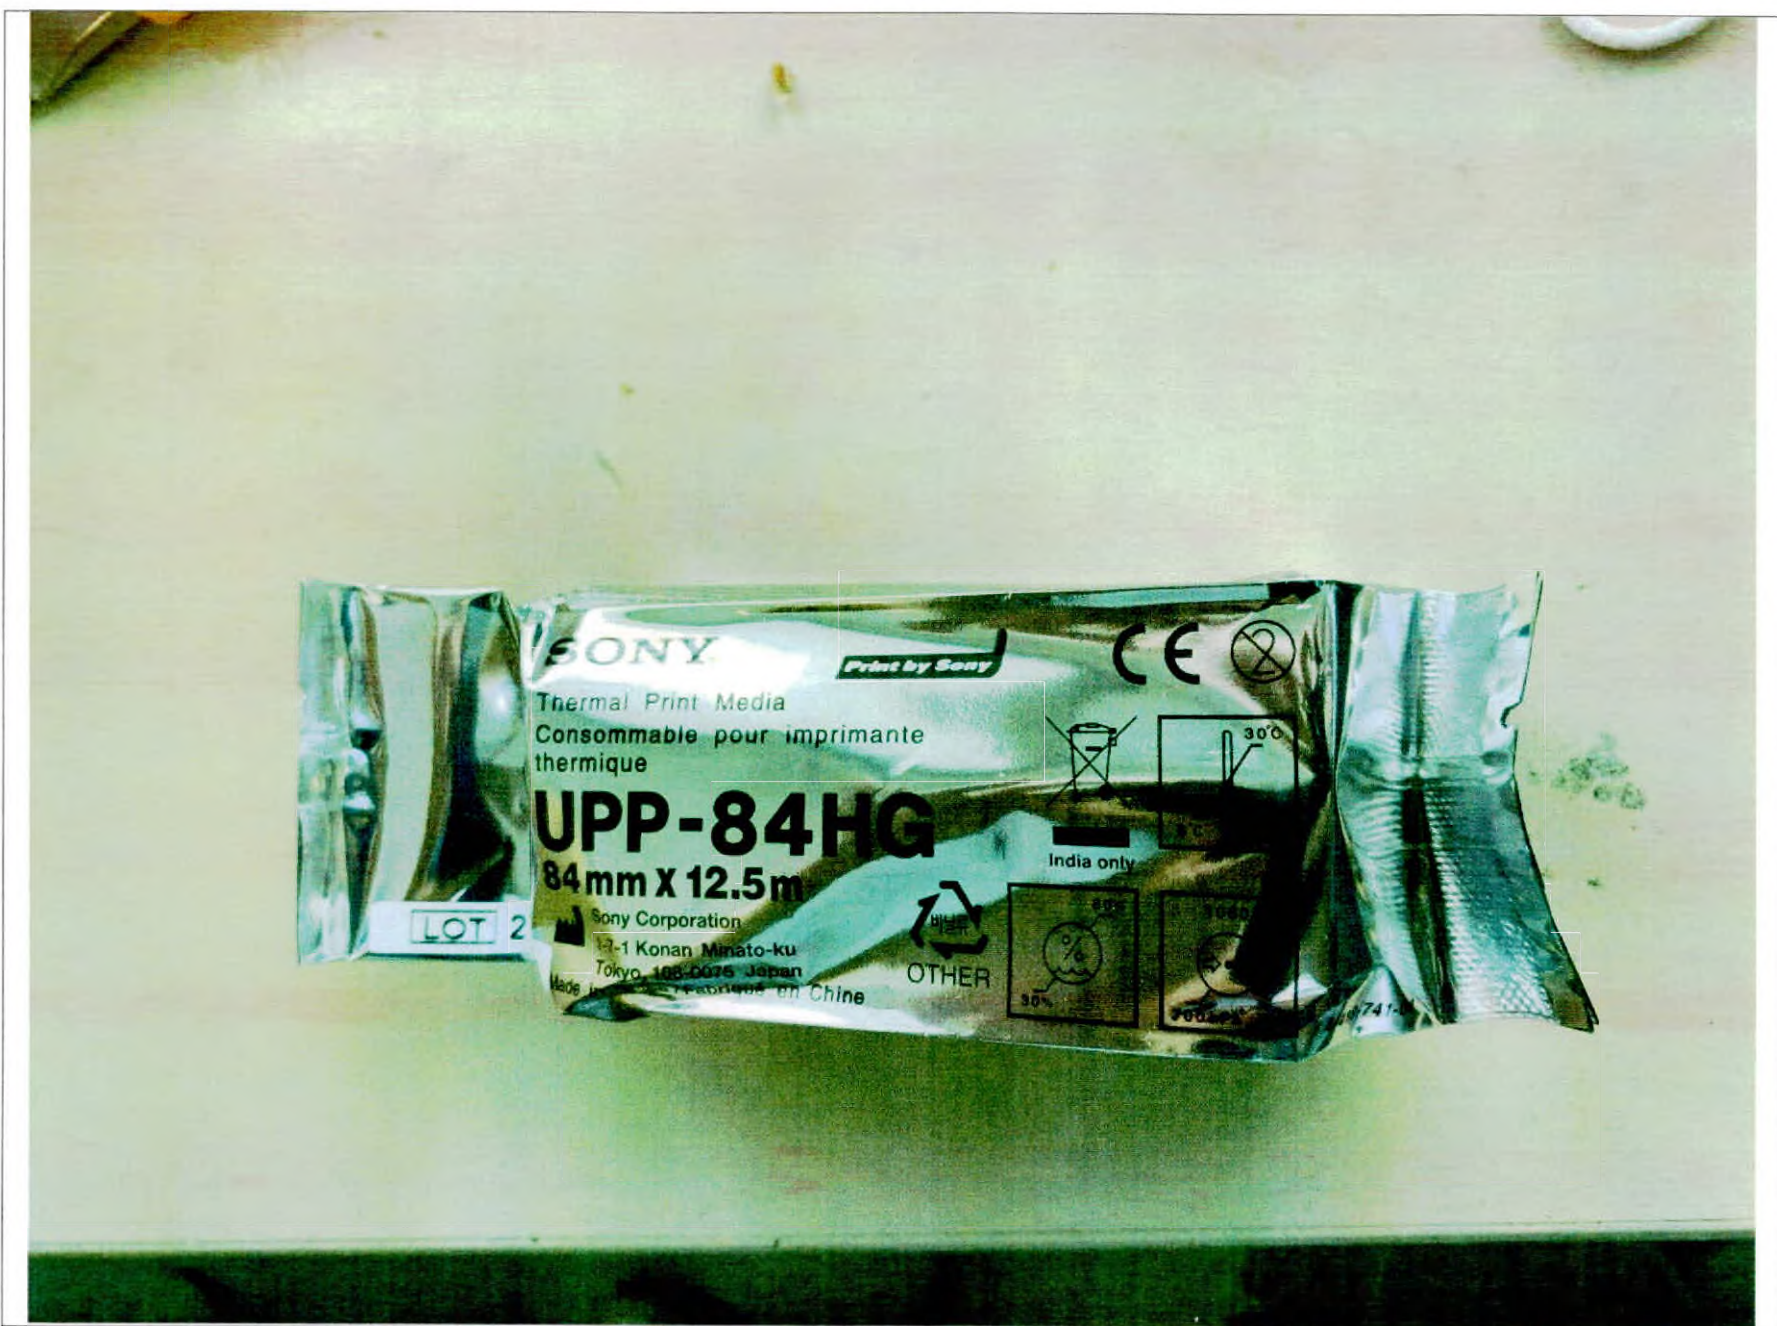

26. Бумага для печати медицинских изображений




27. Защитные оболочки для датчиков

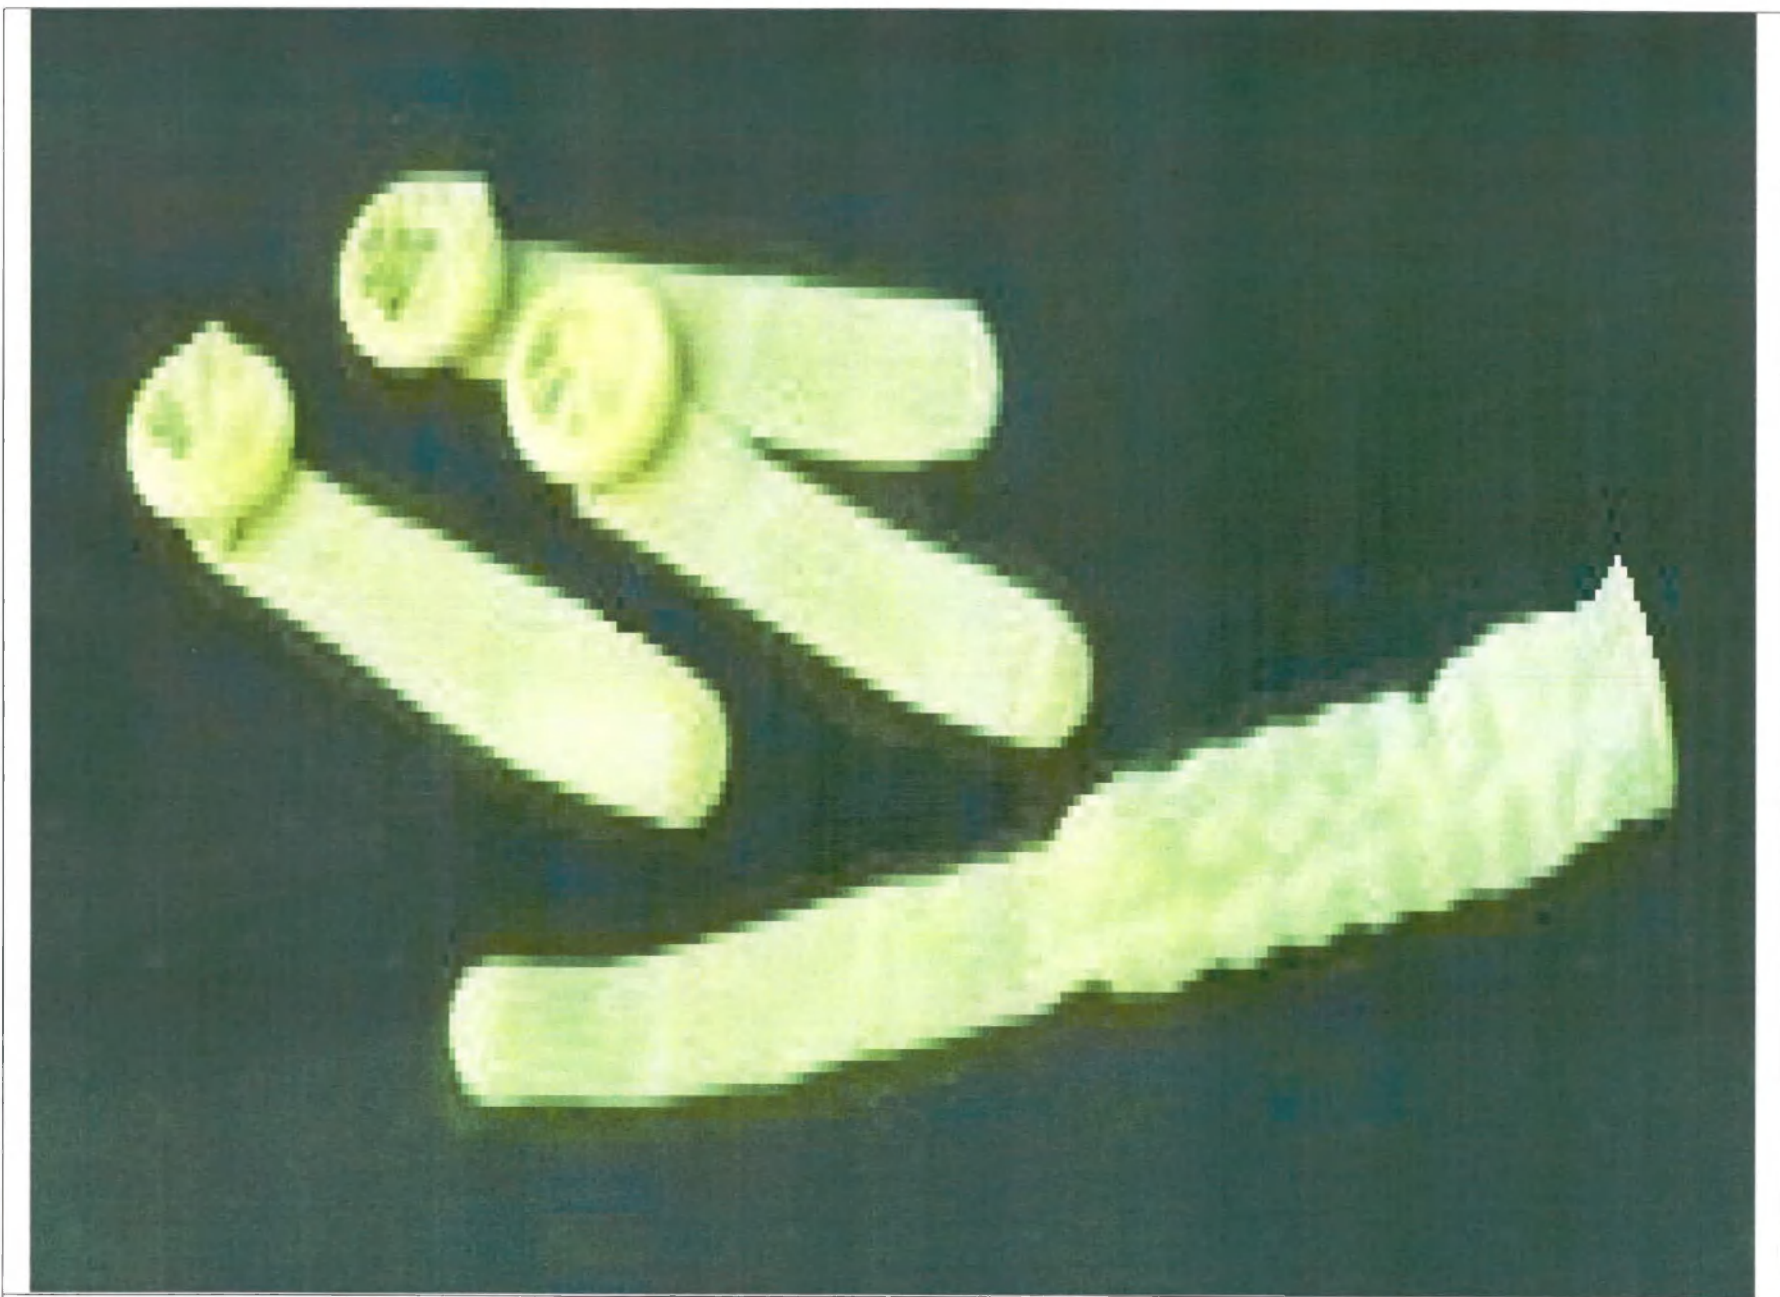


28. Защитные оболочки для внутрисполостных датчиков




29. Адаптер иглопроводника к датчику 4V1

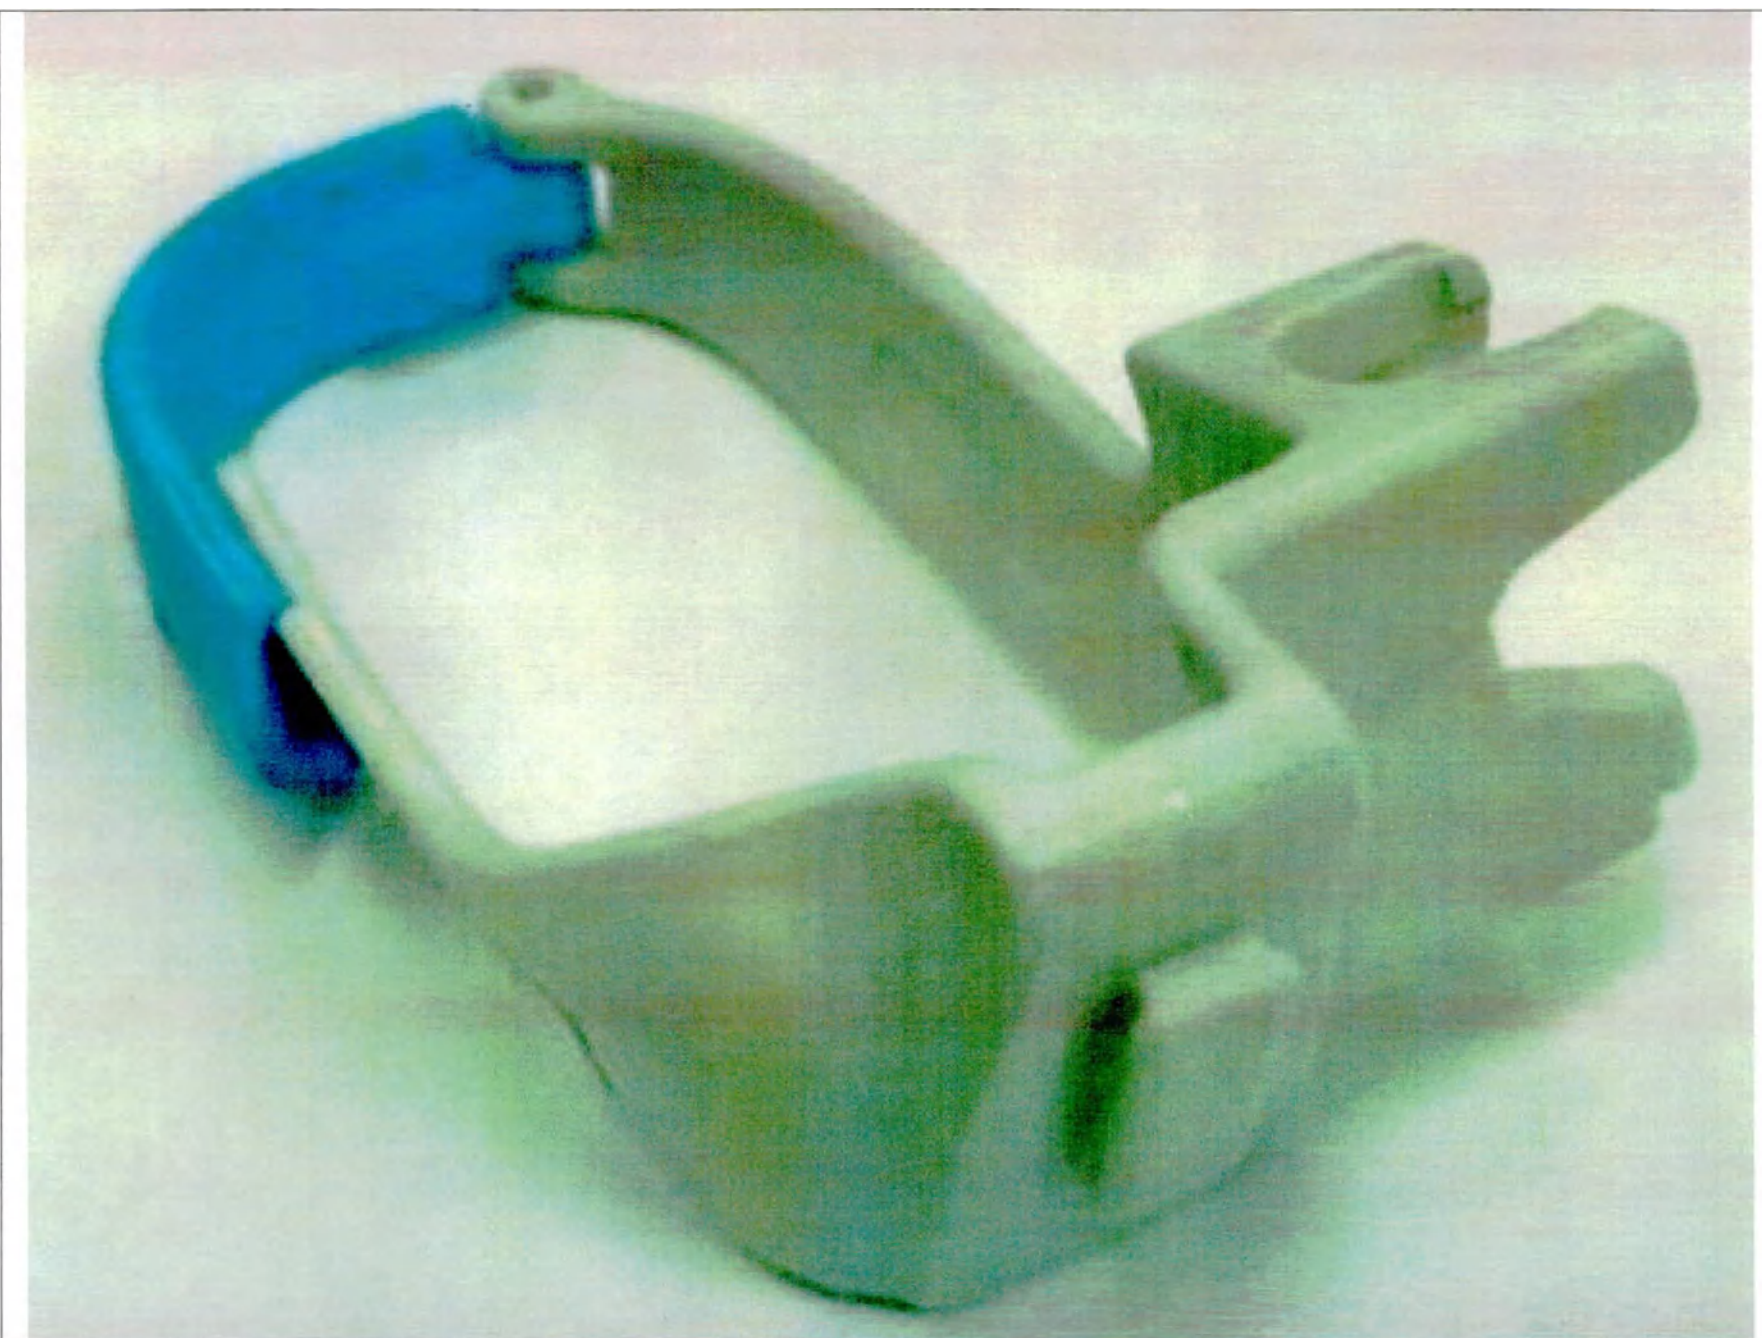


30. Адаптер иглопроводника к датчику 10L4

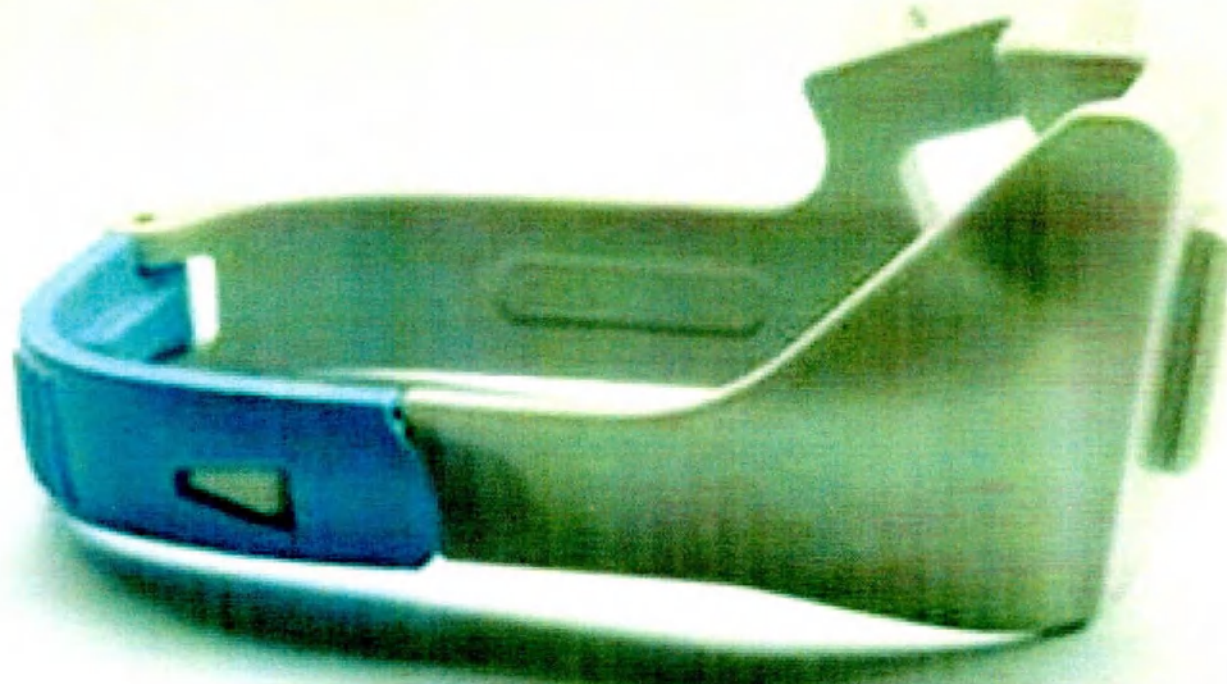


31. Адаптер иглопроводника к датчику 14L5

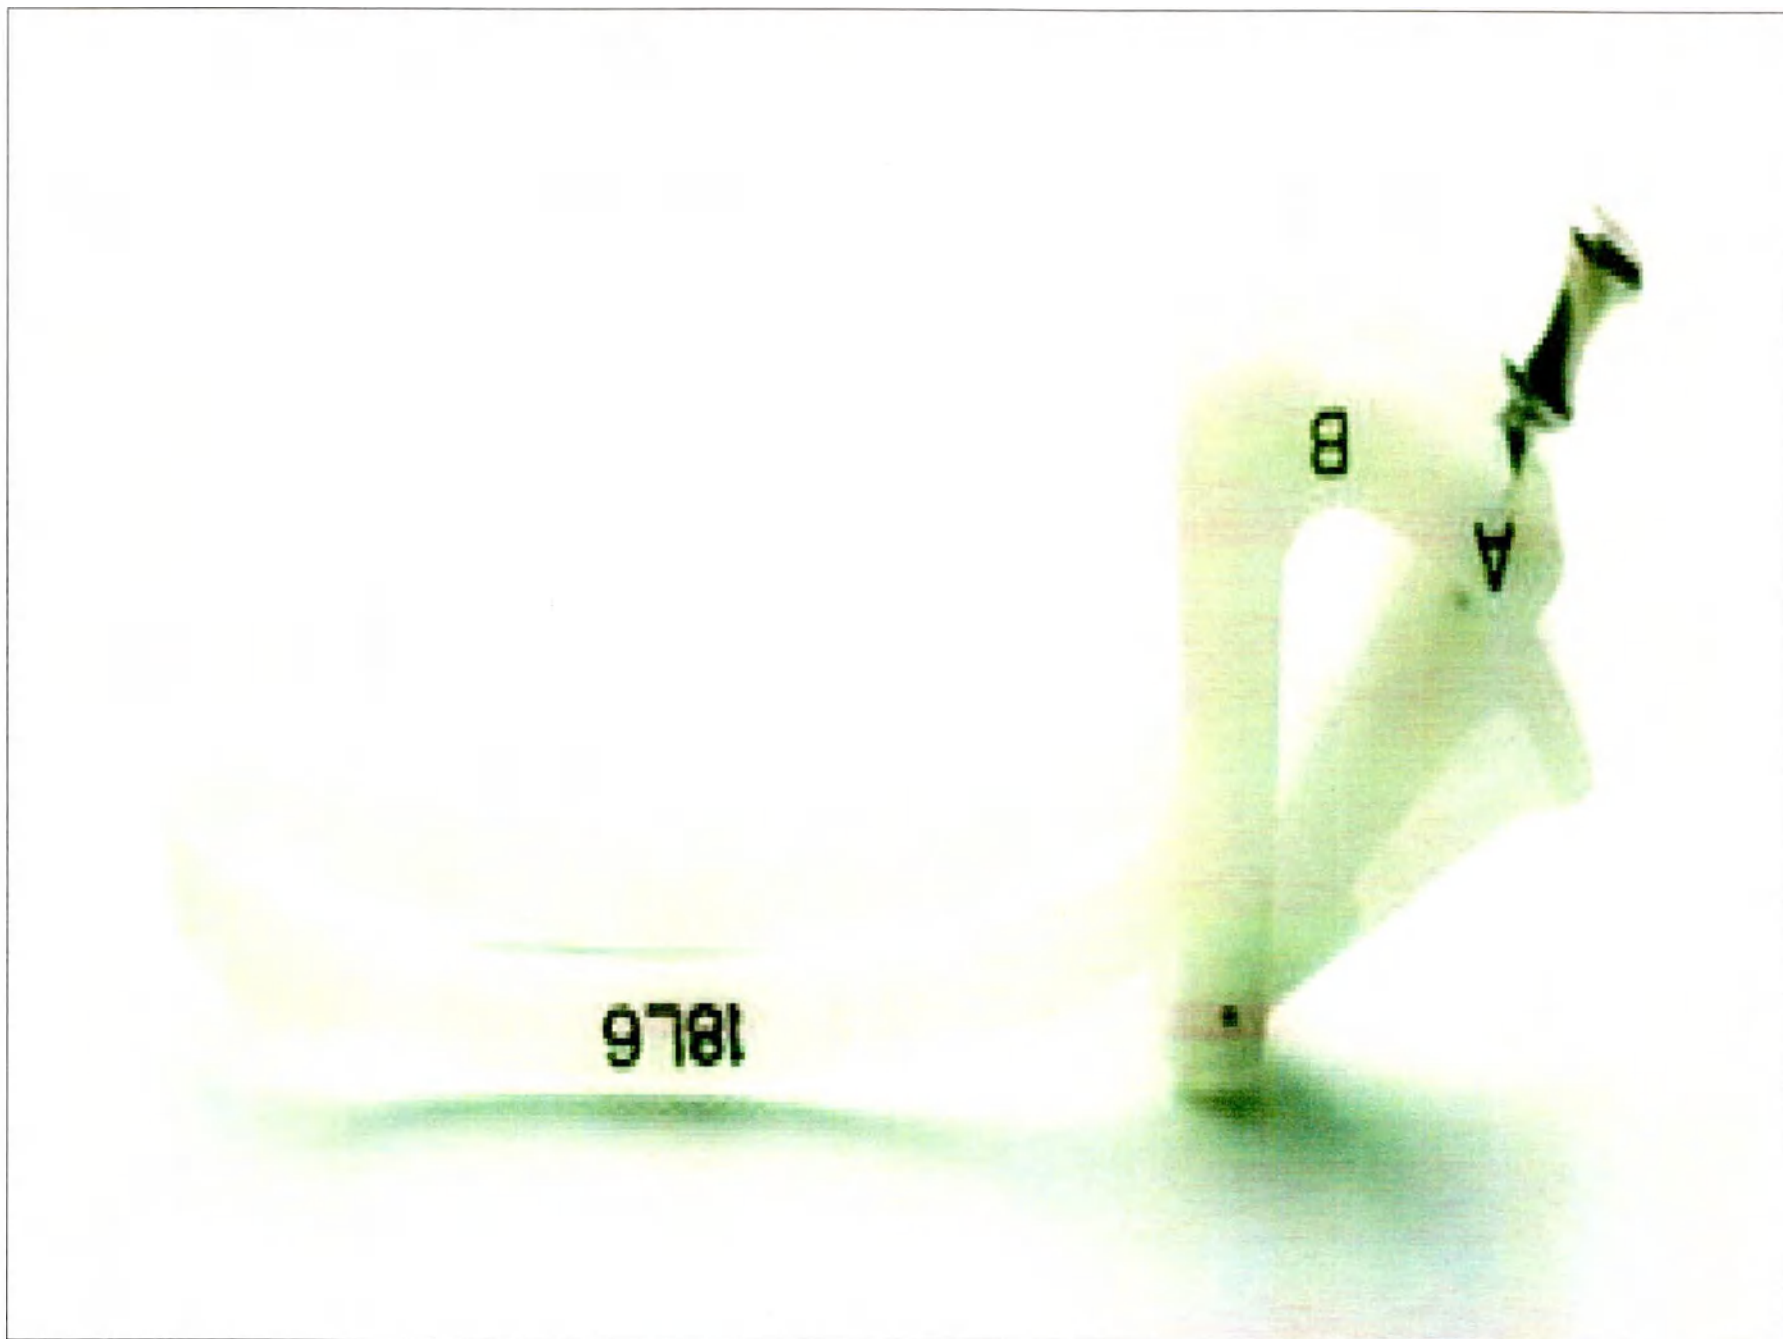


32. Адаптер иглопроводника к датчику 18L6

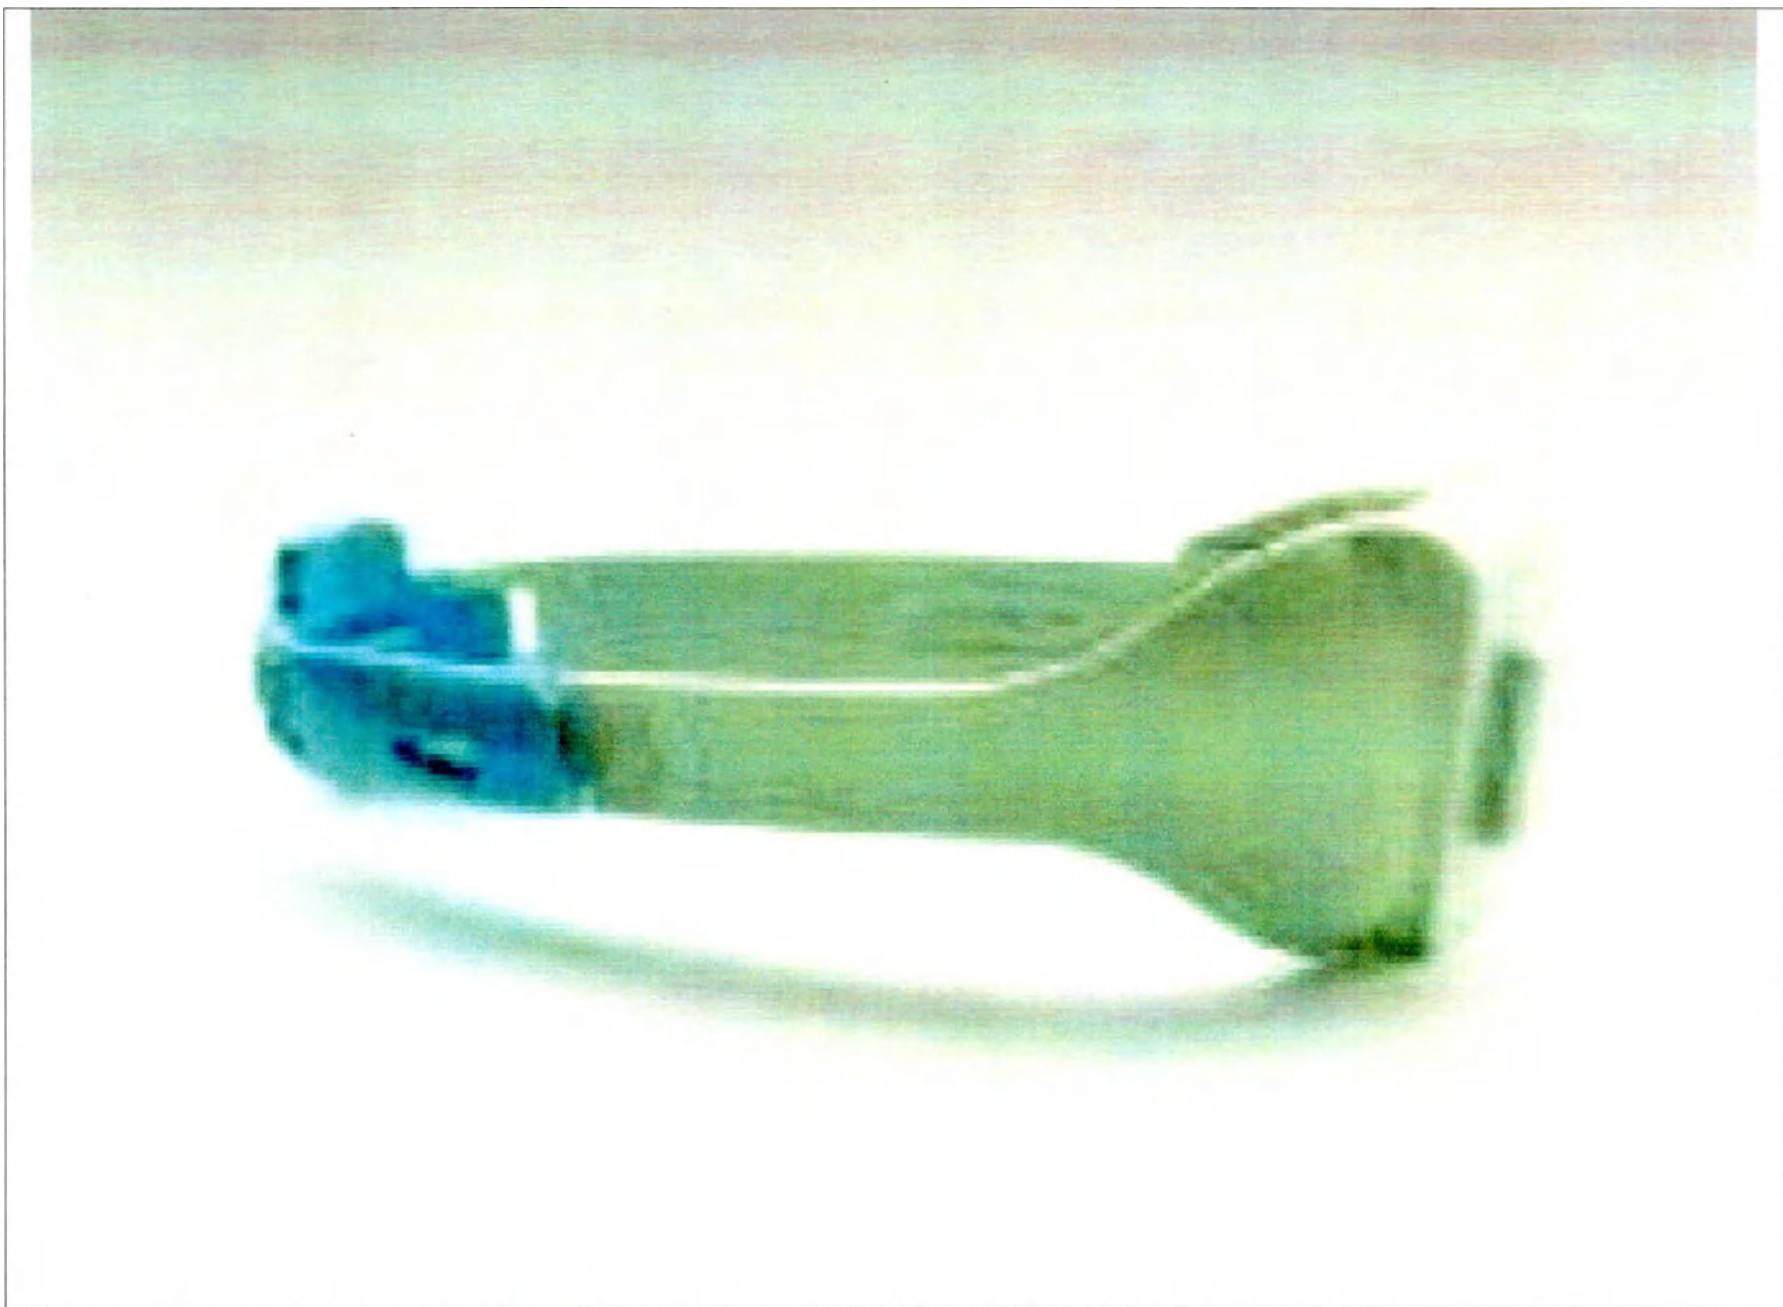


33. Адаптер иглопроводника к датчику 5С1

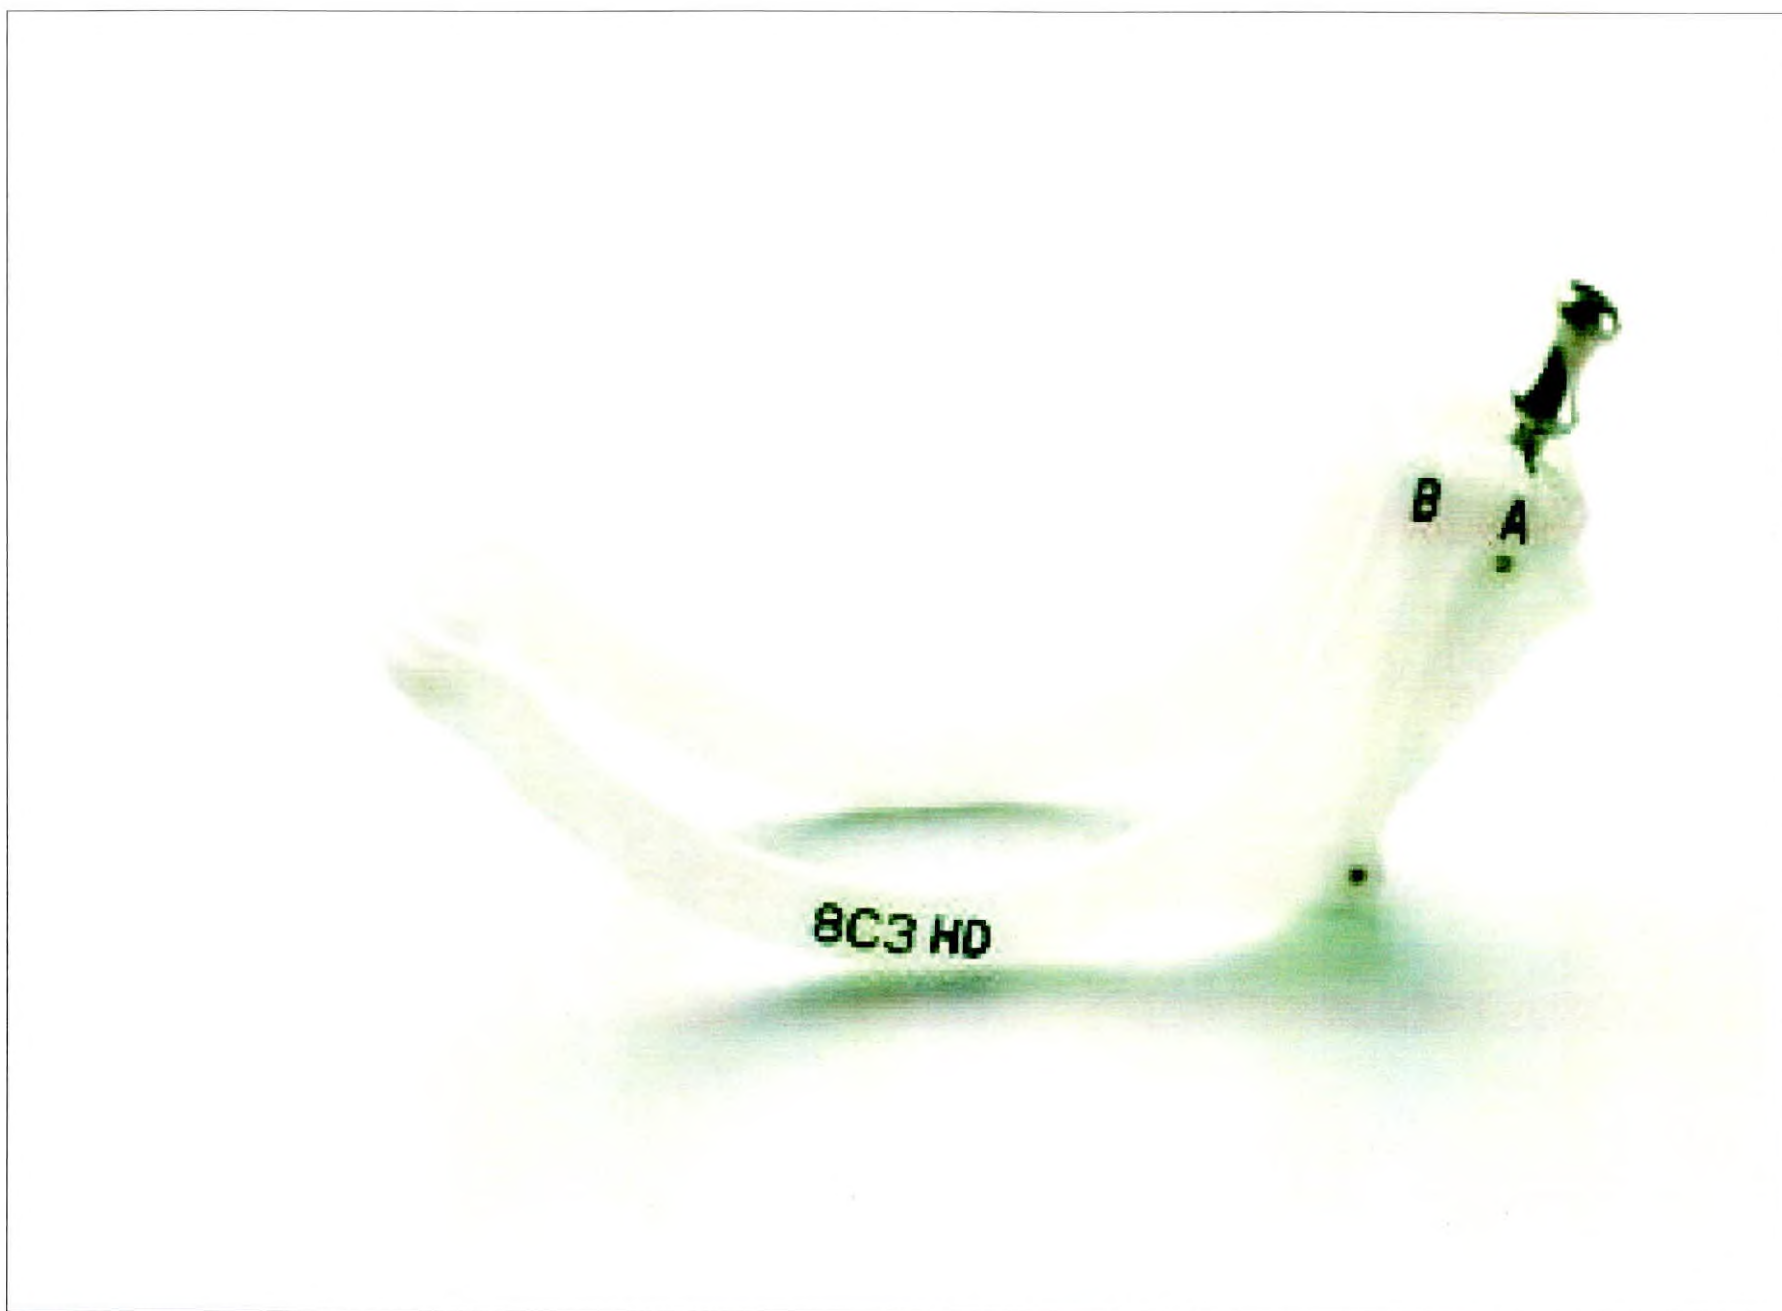


34. Адаптер иглопроводника к датчику 9СЗ

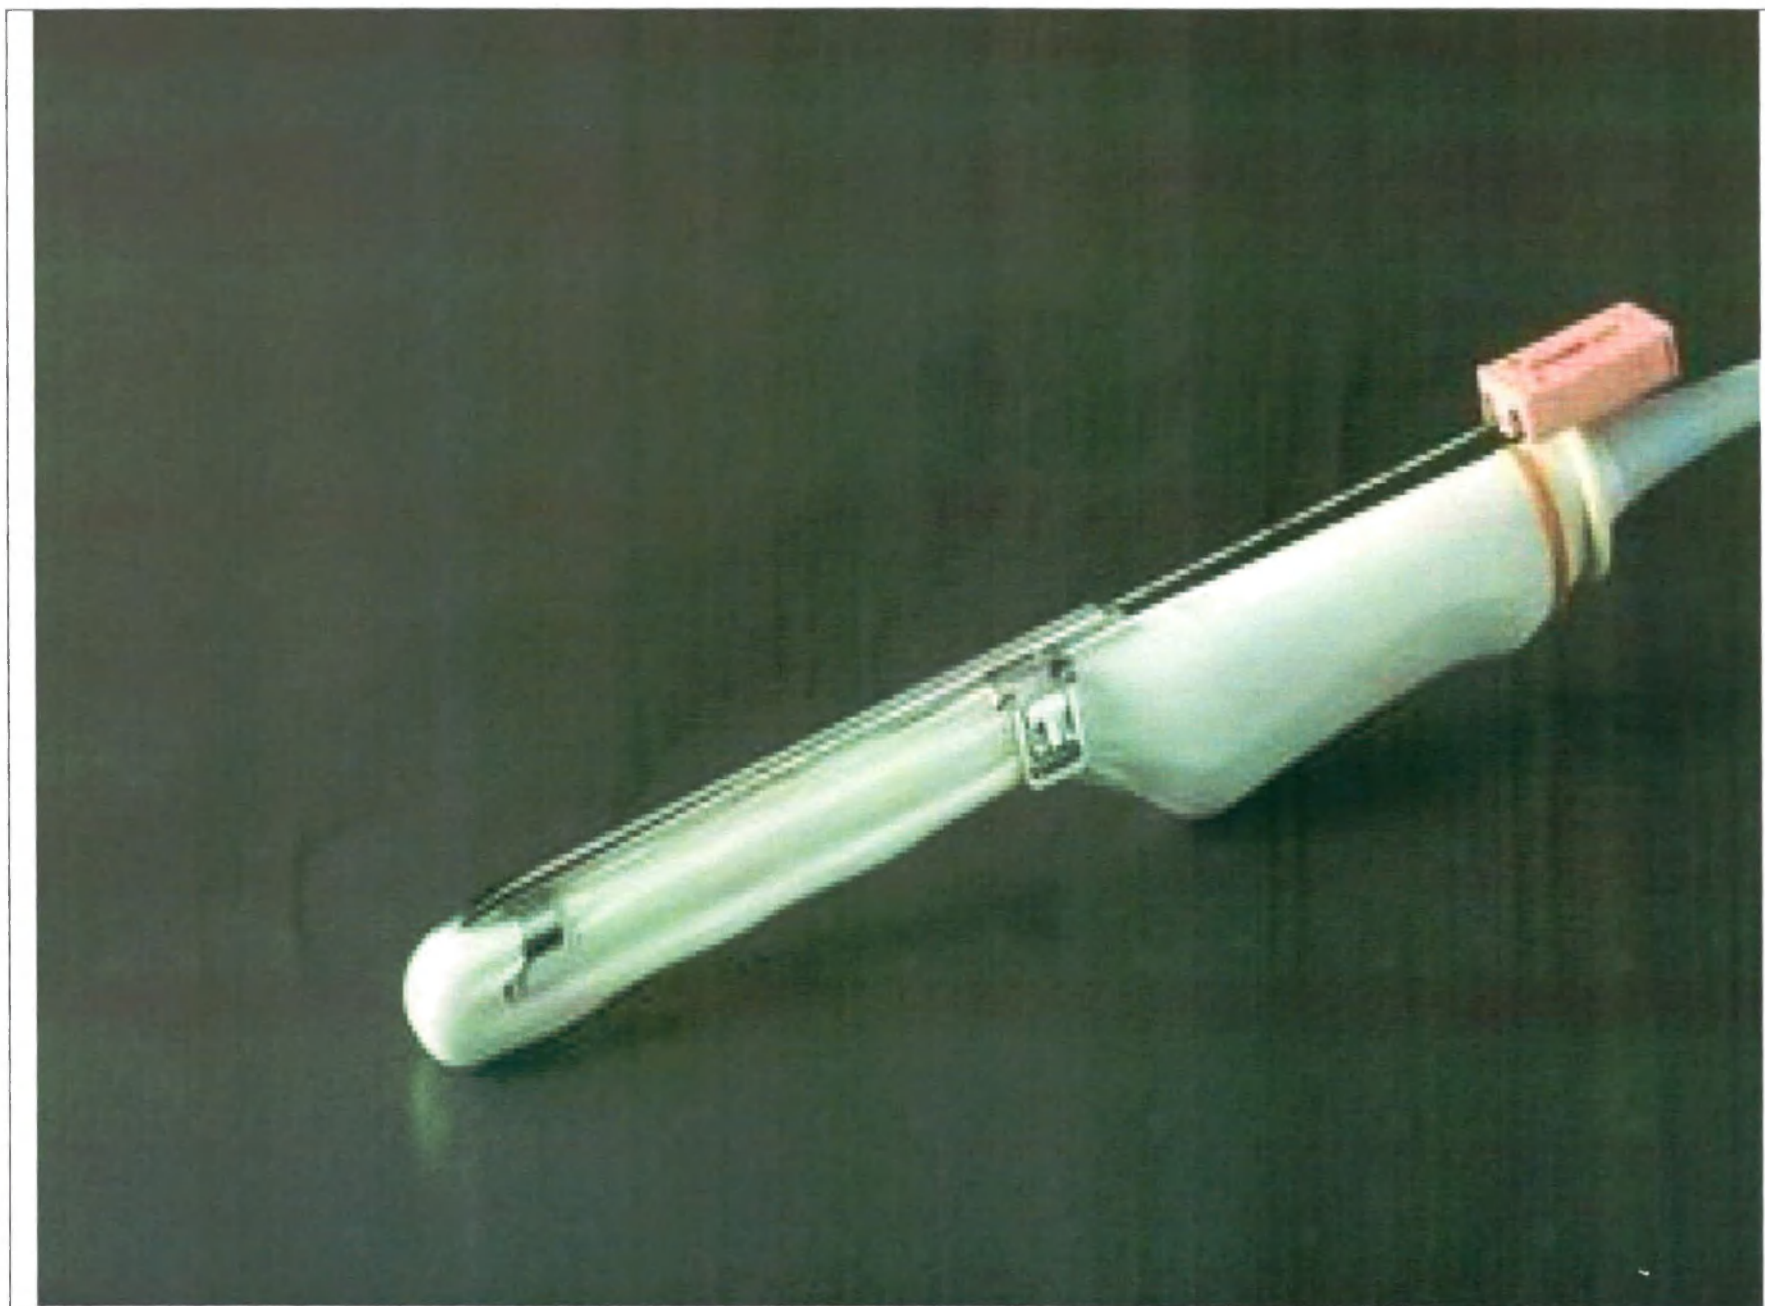


35. Адаптер иглопроводника, многоразовый, к датчику 9ЕС4

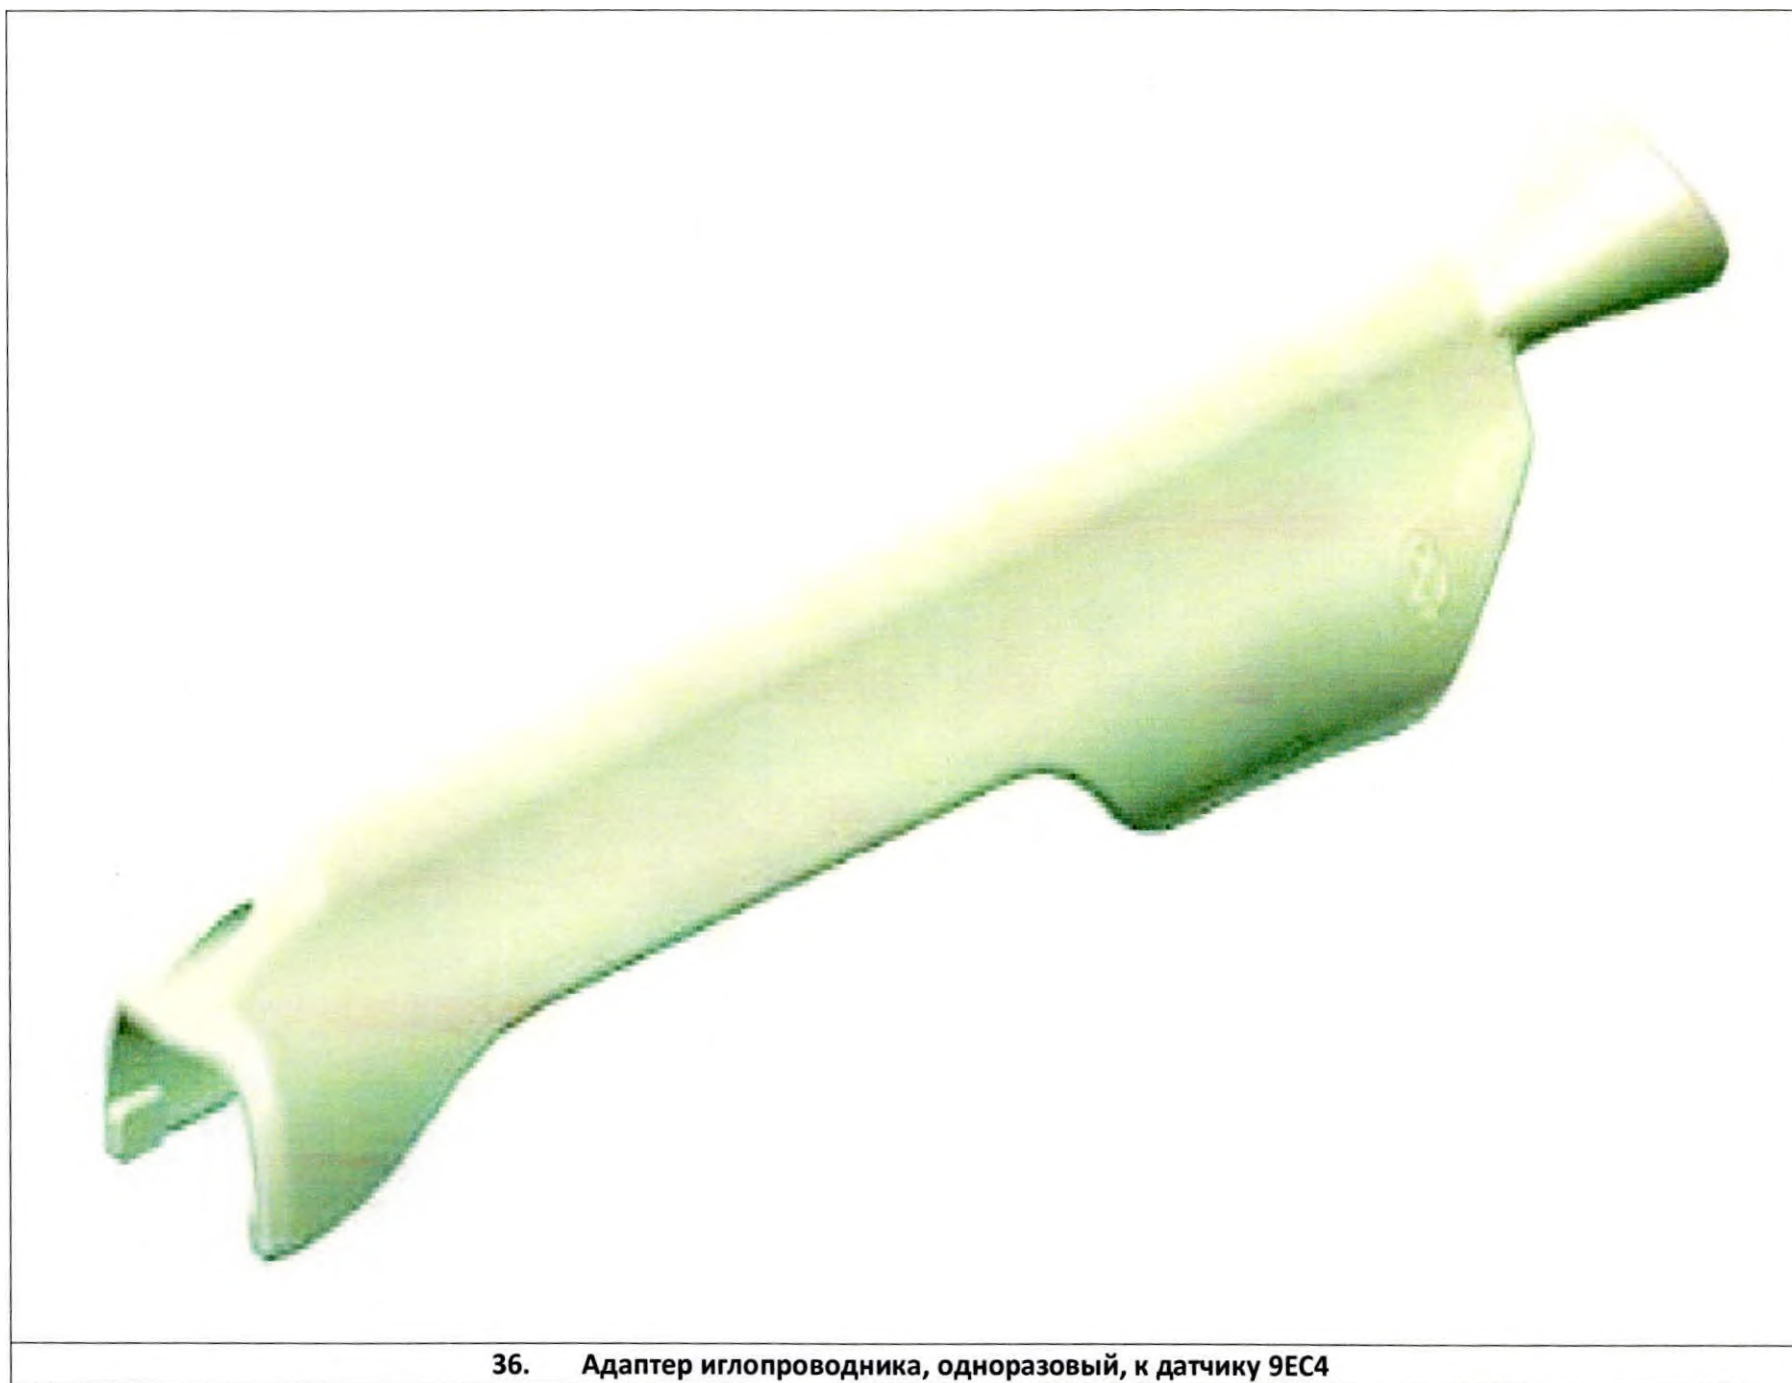

36. Адаптер иглопроводника, одноразовый, к датчику 9ЕС4

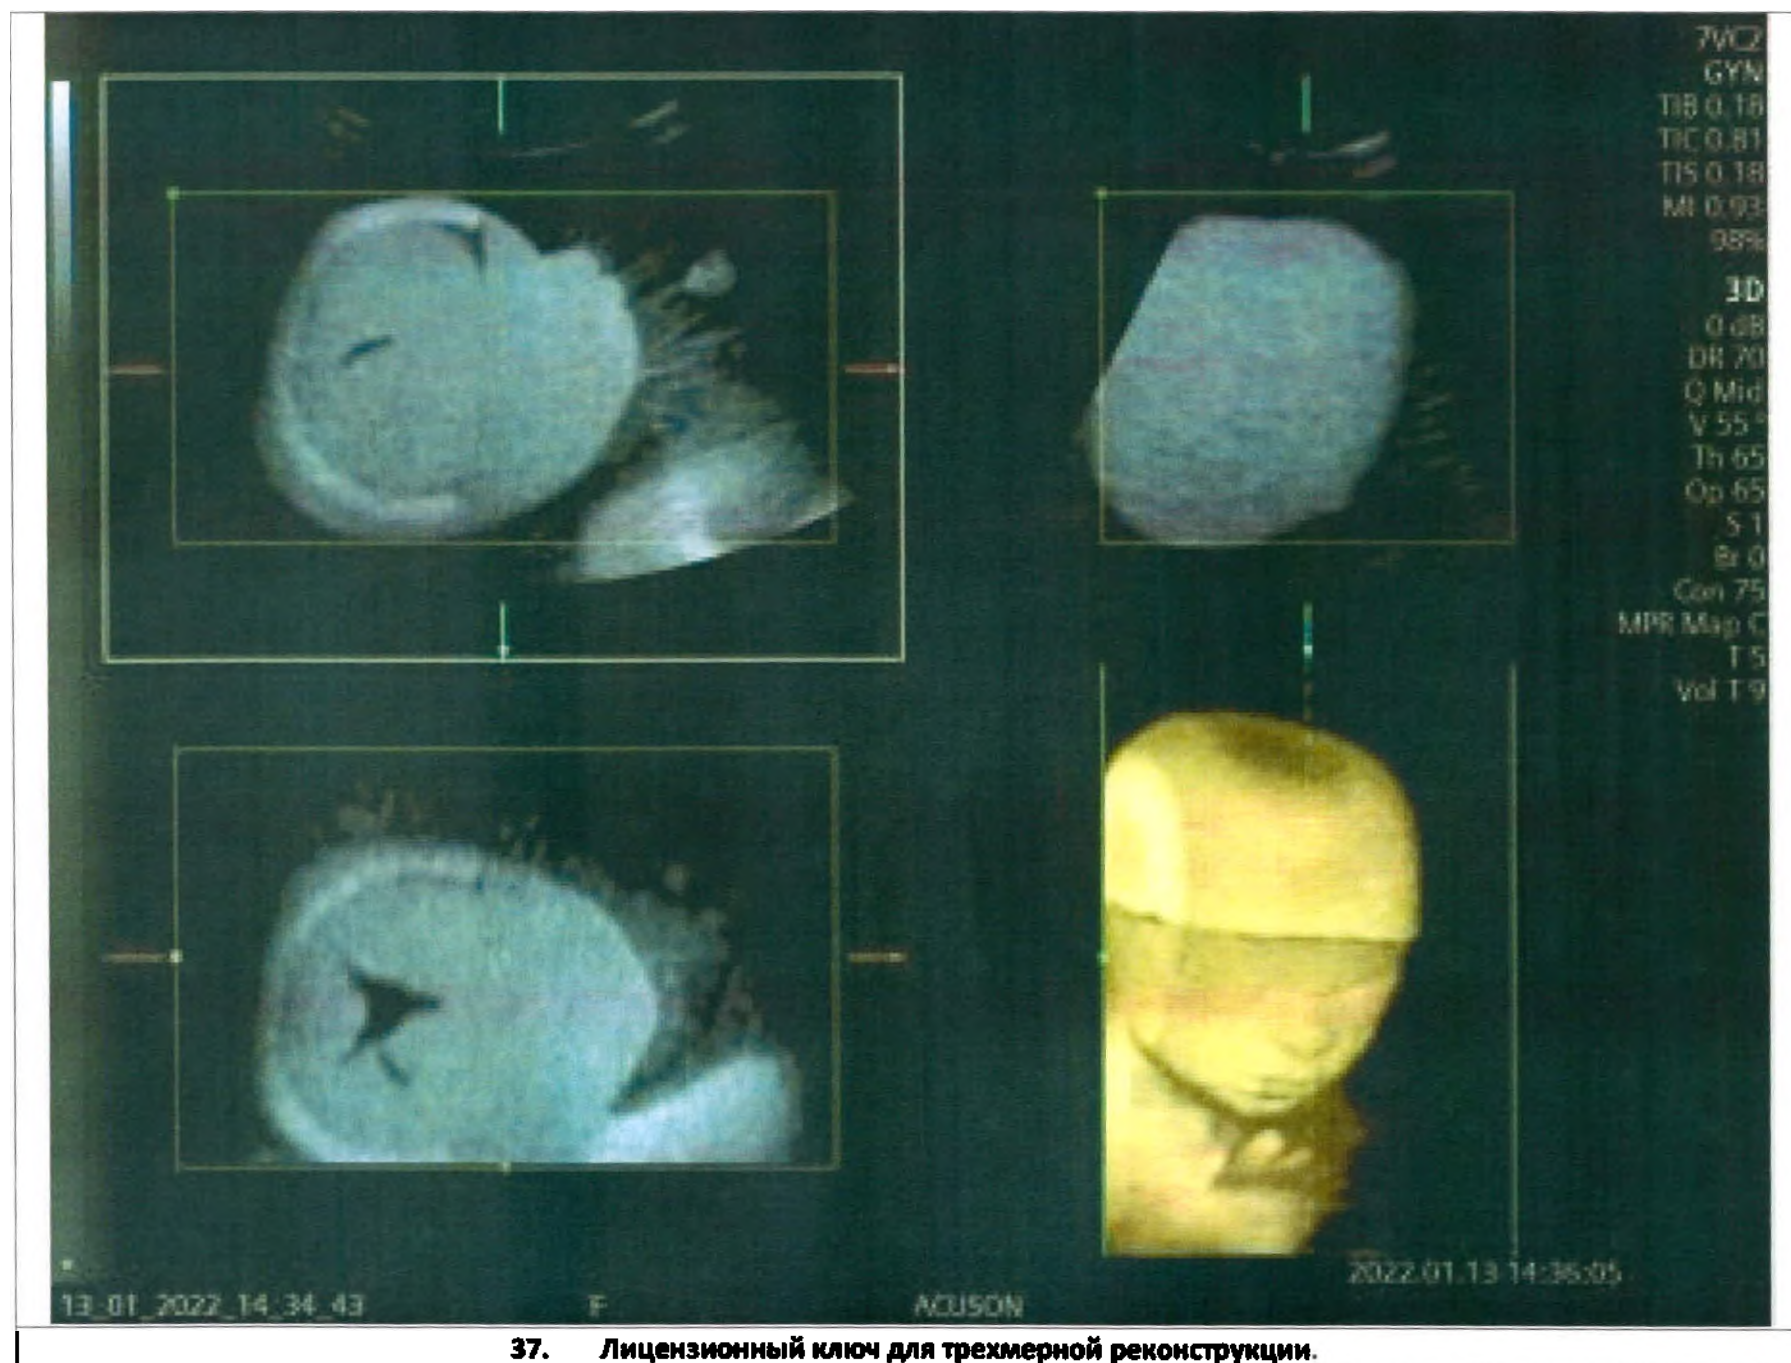

37. Лицензионный ключ для трехмерной реконструкции.

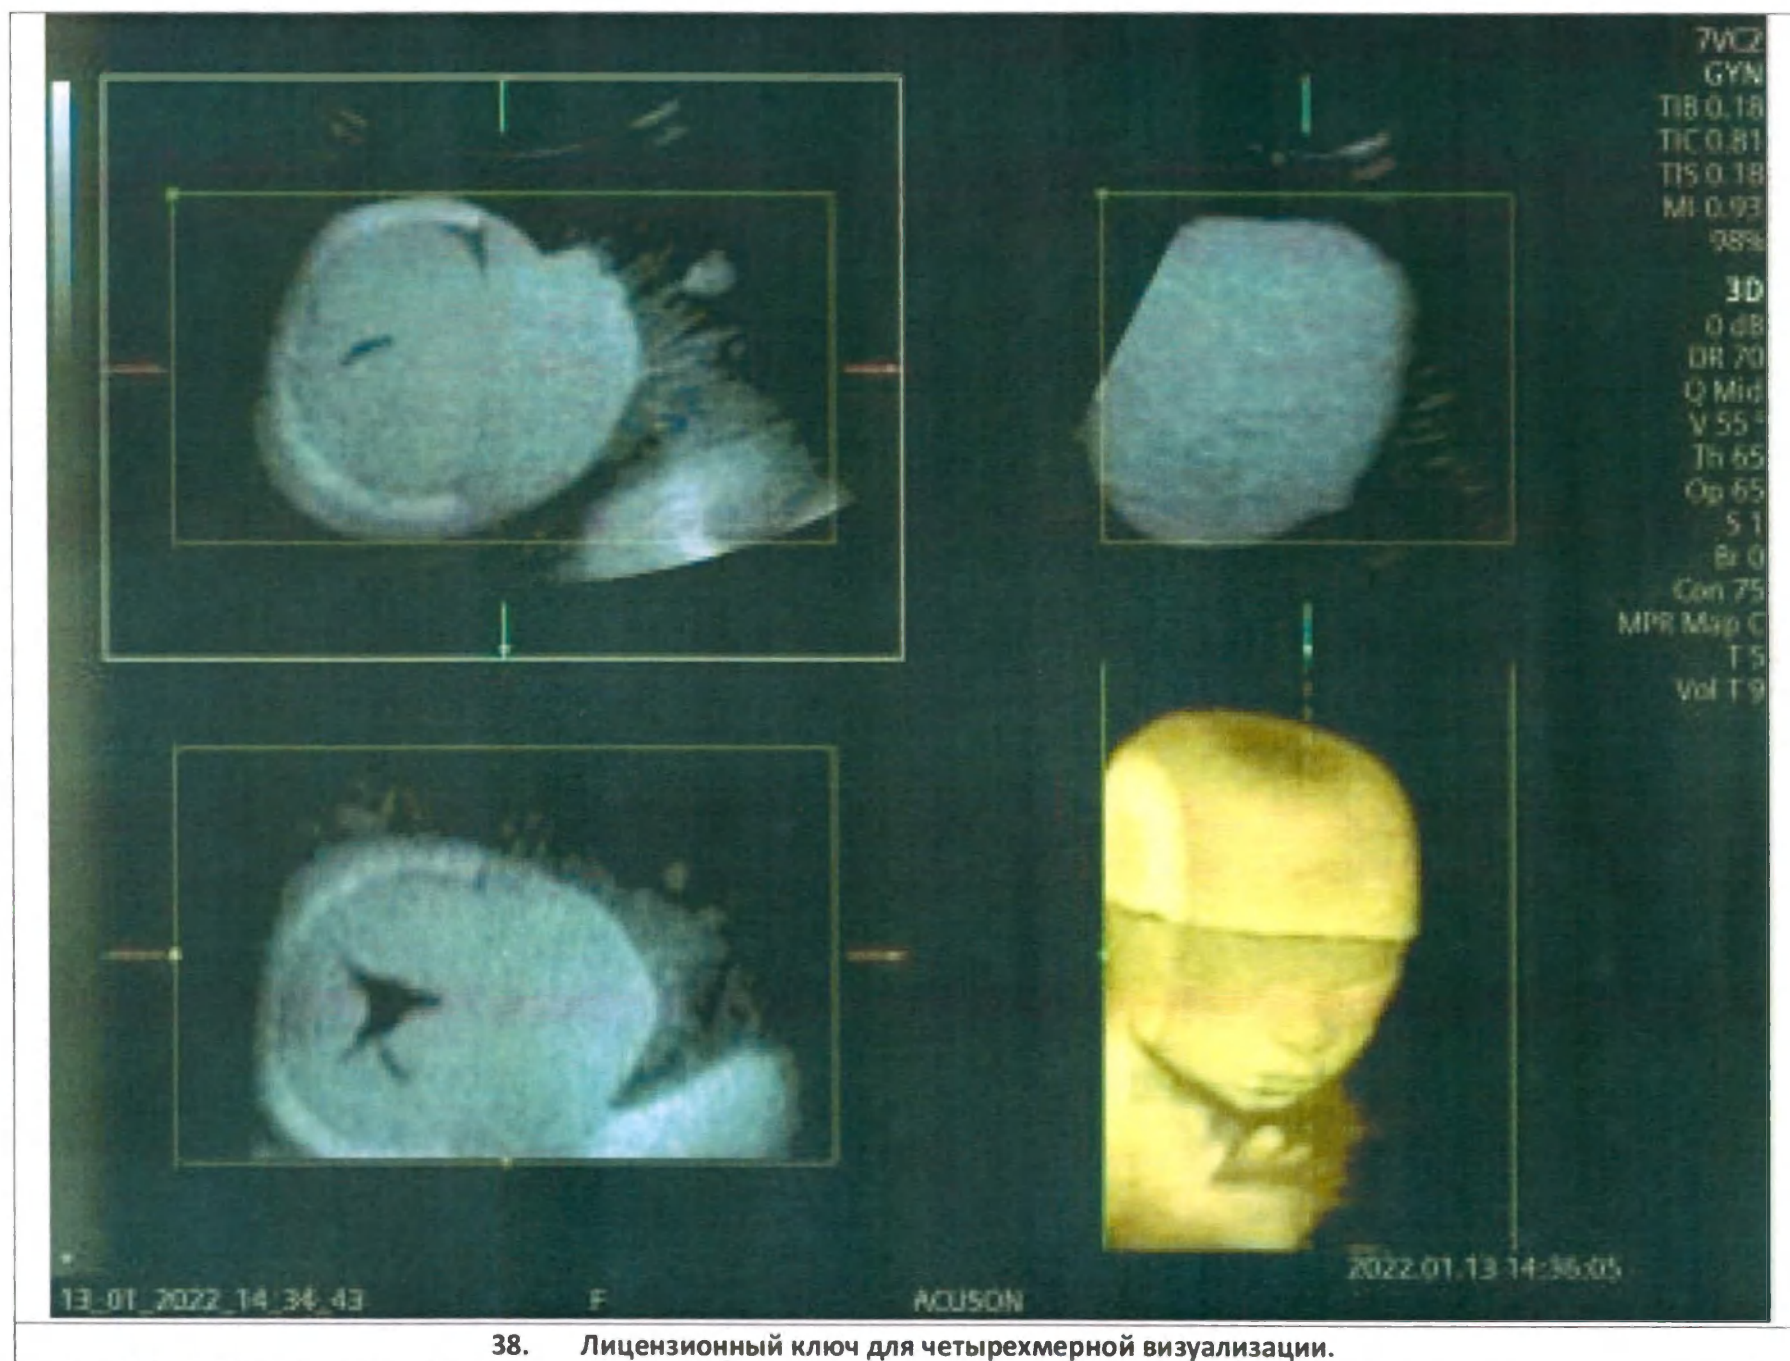

38. Лицензионный ключ для четырехмерной визуализации.

Система ультразвуковая диагностическая ACUSON Redwood с принадлежностями

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от dd.мм.гггг

Страна производства: Корея

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует медицинское изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.96

100 – 240 В

50/60 Гц

5,0 – 2,5 А



Транспортная упаковка системы

После проинформирования,
подтверждено и
скреплено печатью
65 листы (ов)

