



MERCS

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «МЕРС»



Б.Б. Волченко

«30» октября 2023г.

АЛЬБОМ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

«СИСТЕМА ДОСТАВКИ МАТЕРИАЛА ШОВНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО РАССАСЫВАЮЩЕГОСЯ,
СТЕРИЛЬНАЯ, ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ «МЕРС»
ПО ТУ 32.50.13-003-56695793-2022»



**Система доставки материала шовного
хирургического рассасывающегося,
стерильная, однократного применения
«МЕРС» по ТУ 32.50.13-003-56695793-2022**

Грузополучатель: _____

Пункт назначения: _____

Пункт перегрузки: _____

____ × ____ × ____ см

БРУТТО – ____ кг

НЕТТО – ____ кг



ООО «МЕРС»
420127, Россия,
Республика Татарстан,
г. Казань, ул.
Дементьева, д. 1,
помещ. 1

Фото 1. Пример маркировки транспортной упаковки медицинского изделия

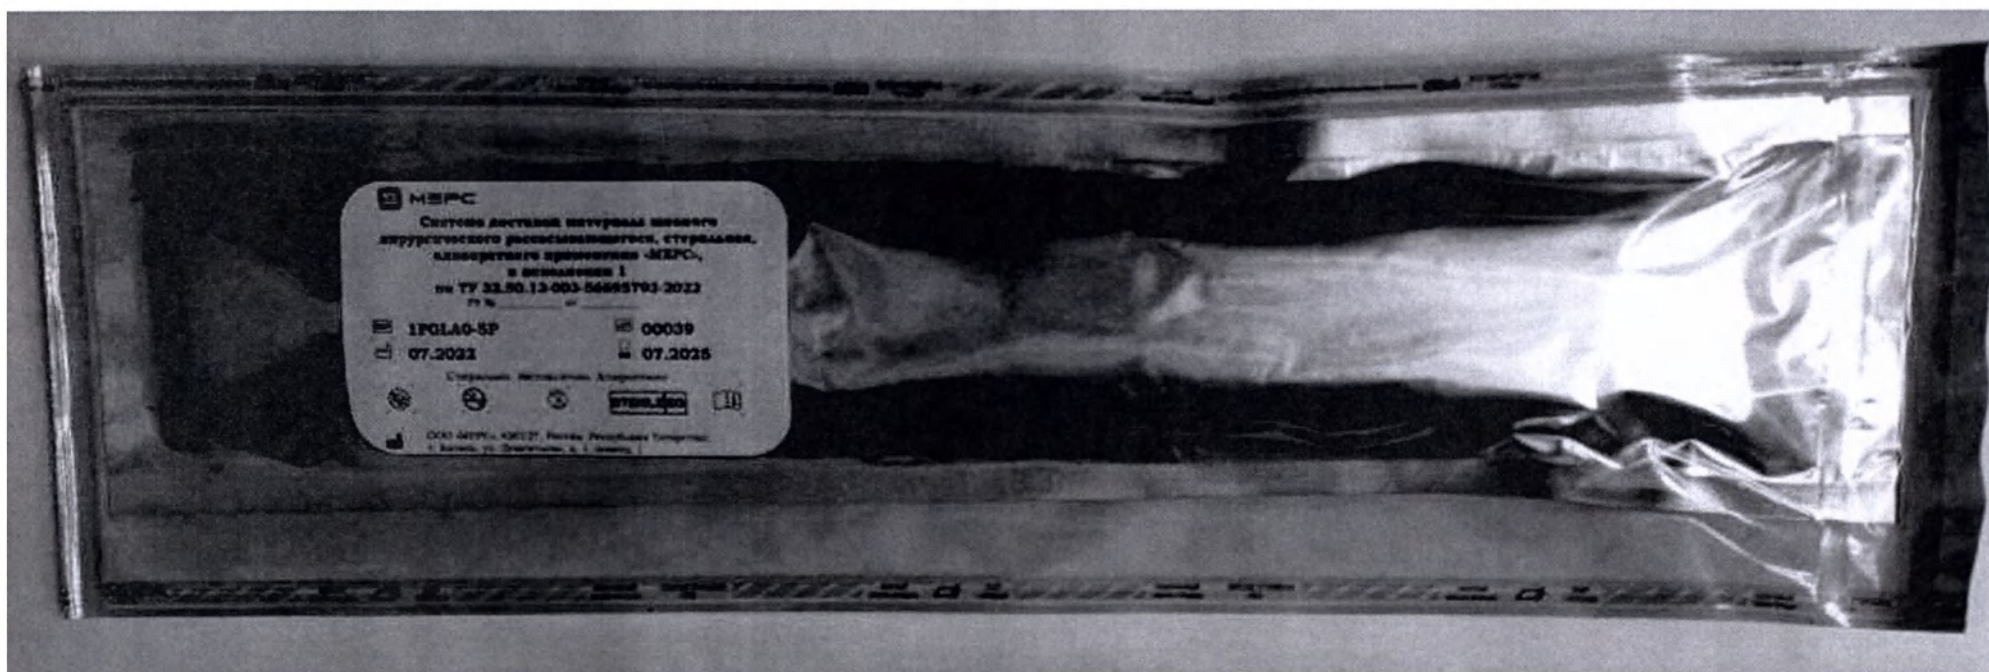
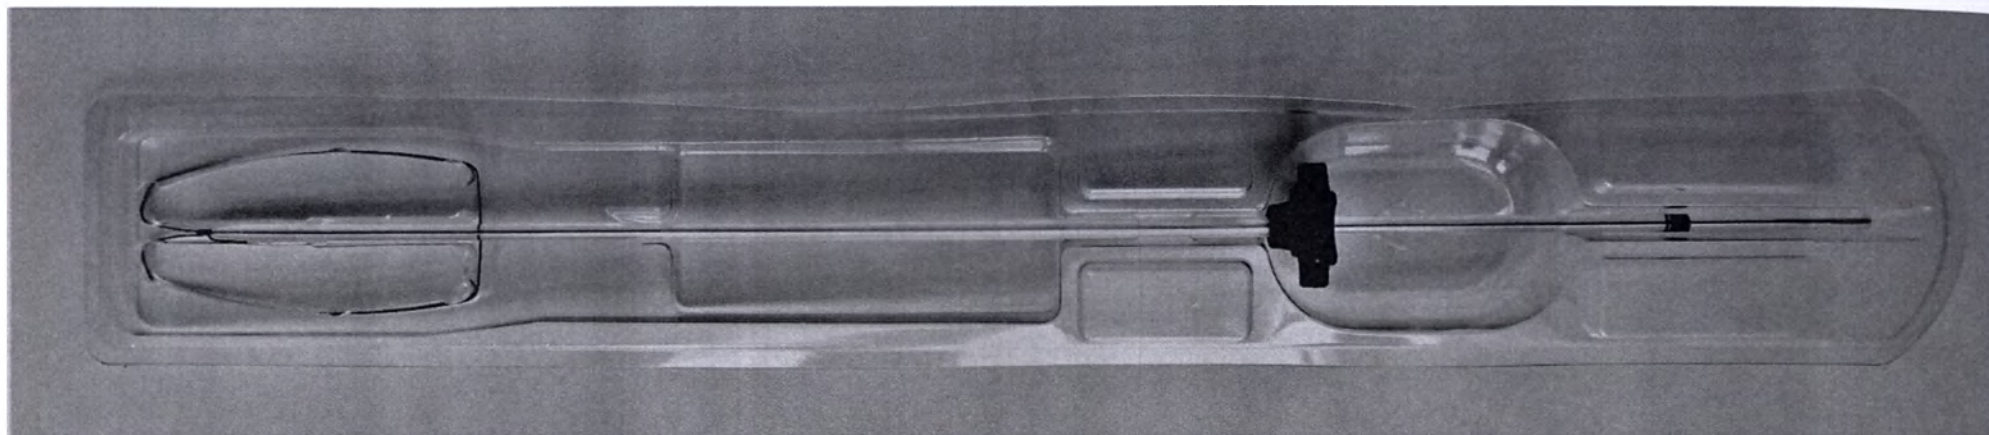


Фото 2. Пример потребительской индивидуальной упаковки и маркировки
Системы доставки материала шовного хирургического рассасывающегося, стерильной, однократного применения «МЕРС»
по ТУ 32.50.13-003-56695793-2022

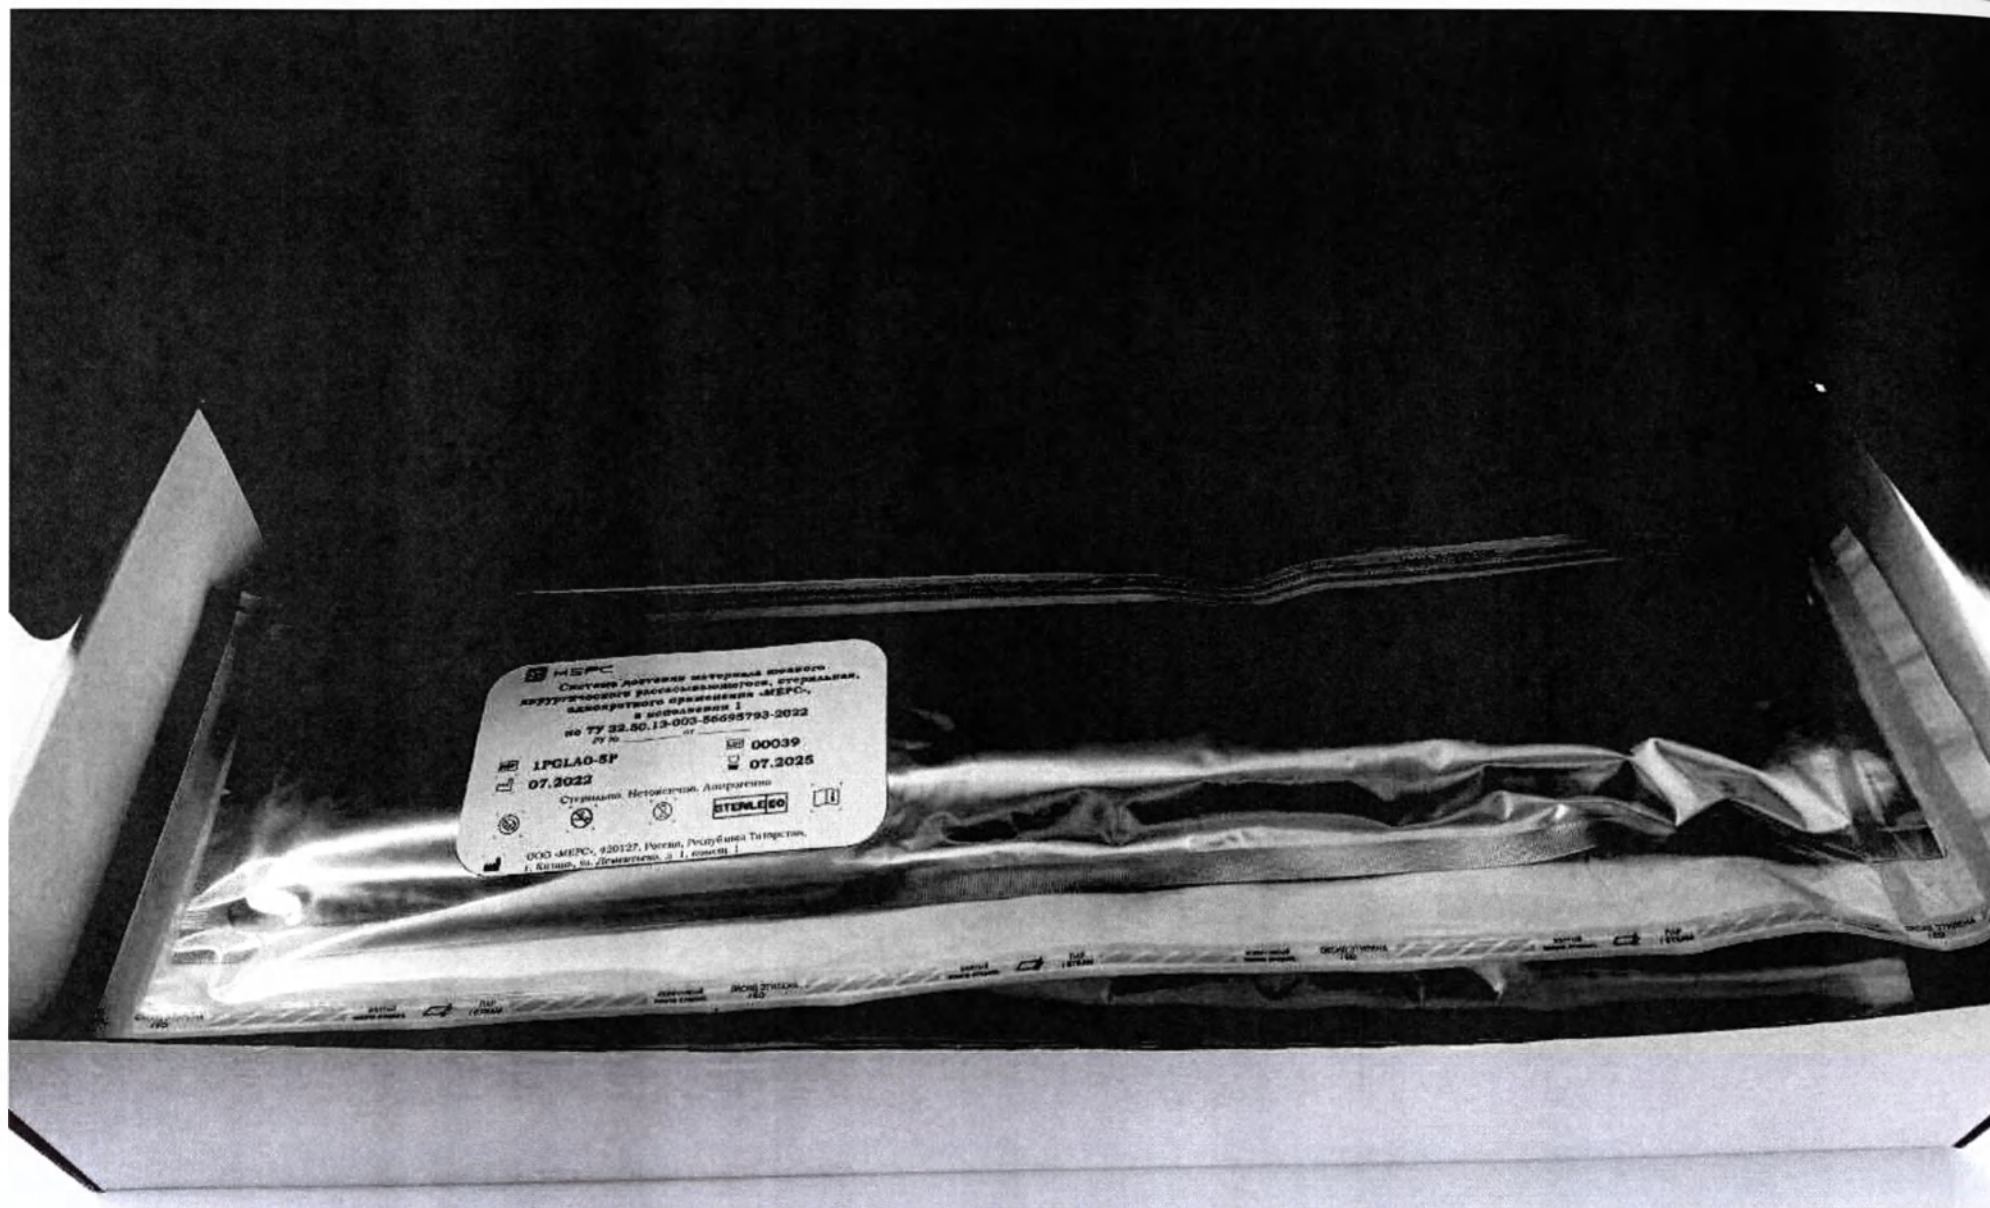


Фото 3. Пример потребительской групповой упаковки
Системы доставки материала шовного хирургического рассасывающегося, стерильной, однократного применения «МЕРС»
по ТУ 32.50.13-003-56695793-2022

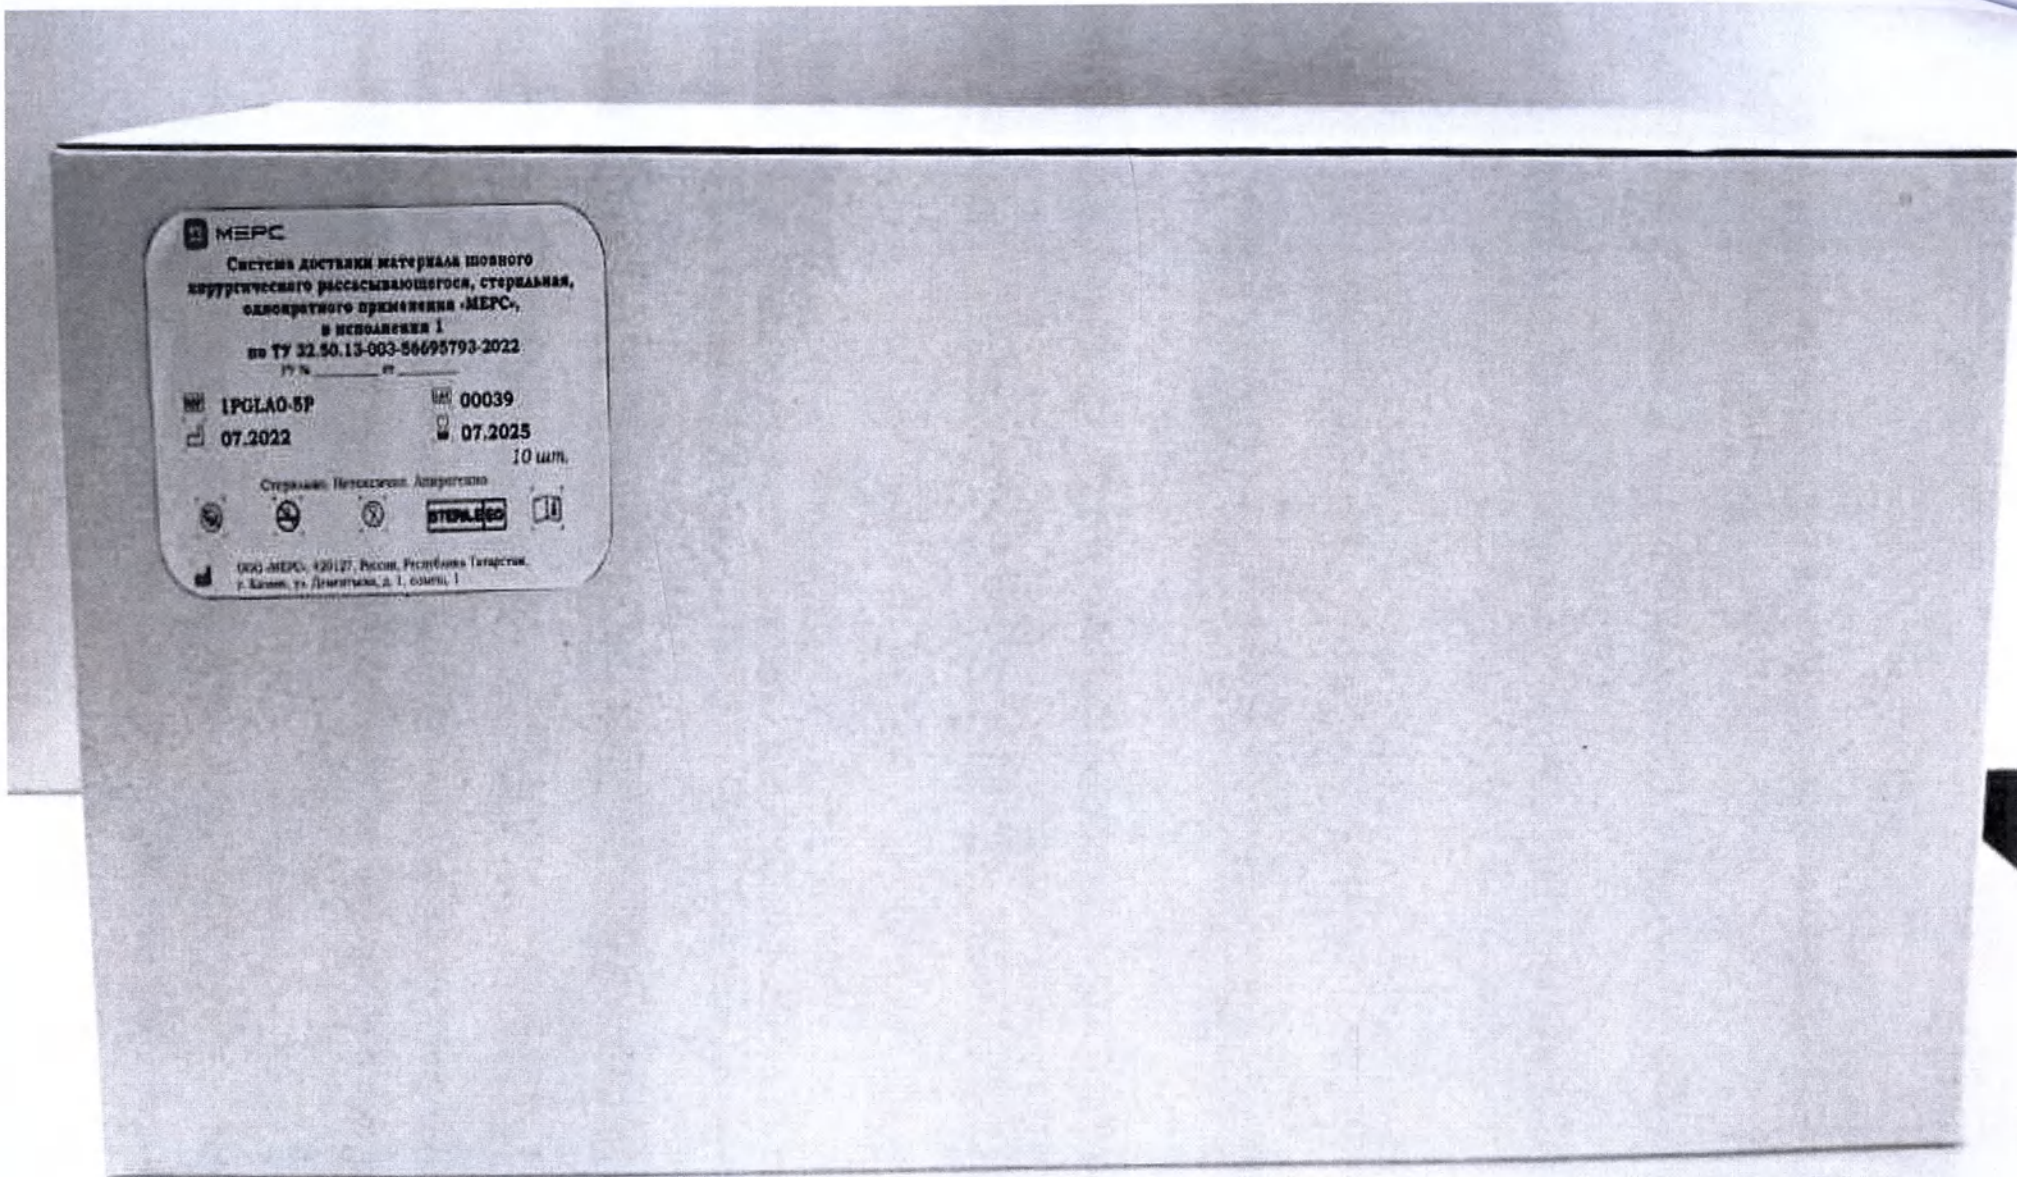


Фото 4. Пример потребительской групповой упаковки и маркировки
Системы доставки материала шовного хирургического рассасывающегося, стерильной, однократного применения «МЕРС»
по ТУ 32.50.13-003-56695793-2022

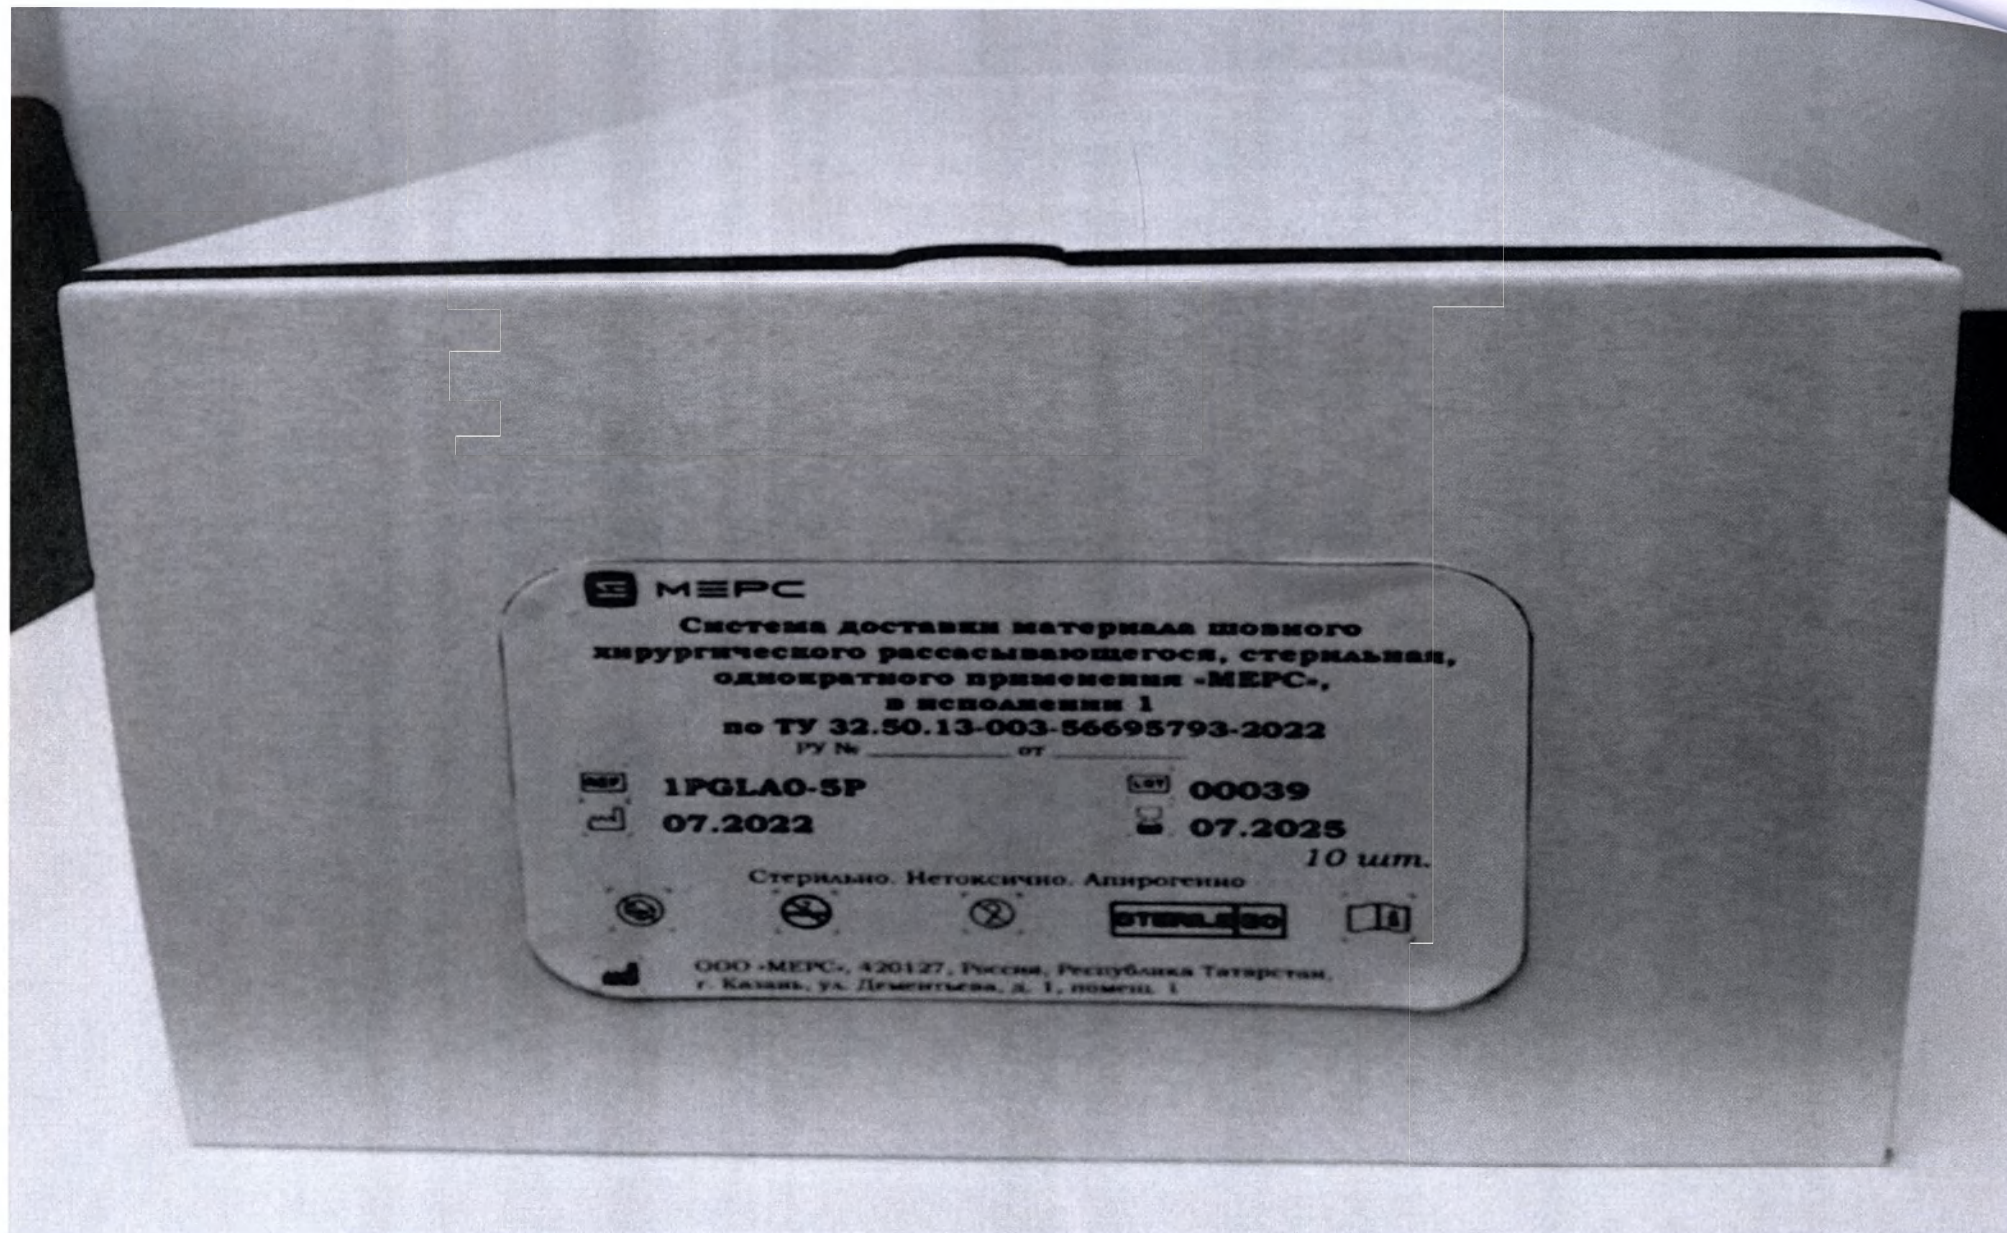


Фото 5. Пример потребительской групповой упаковки и маркировки
Системы доставки материала шовного хирургического рассасывающегося, стерильной, однократного применения «МЕРС»
по ТУ 32.50.13-003-56695793-2022

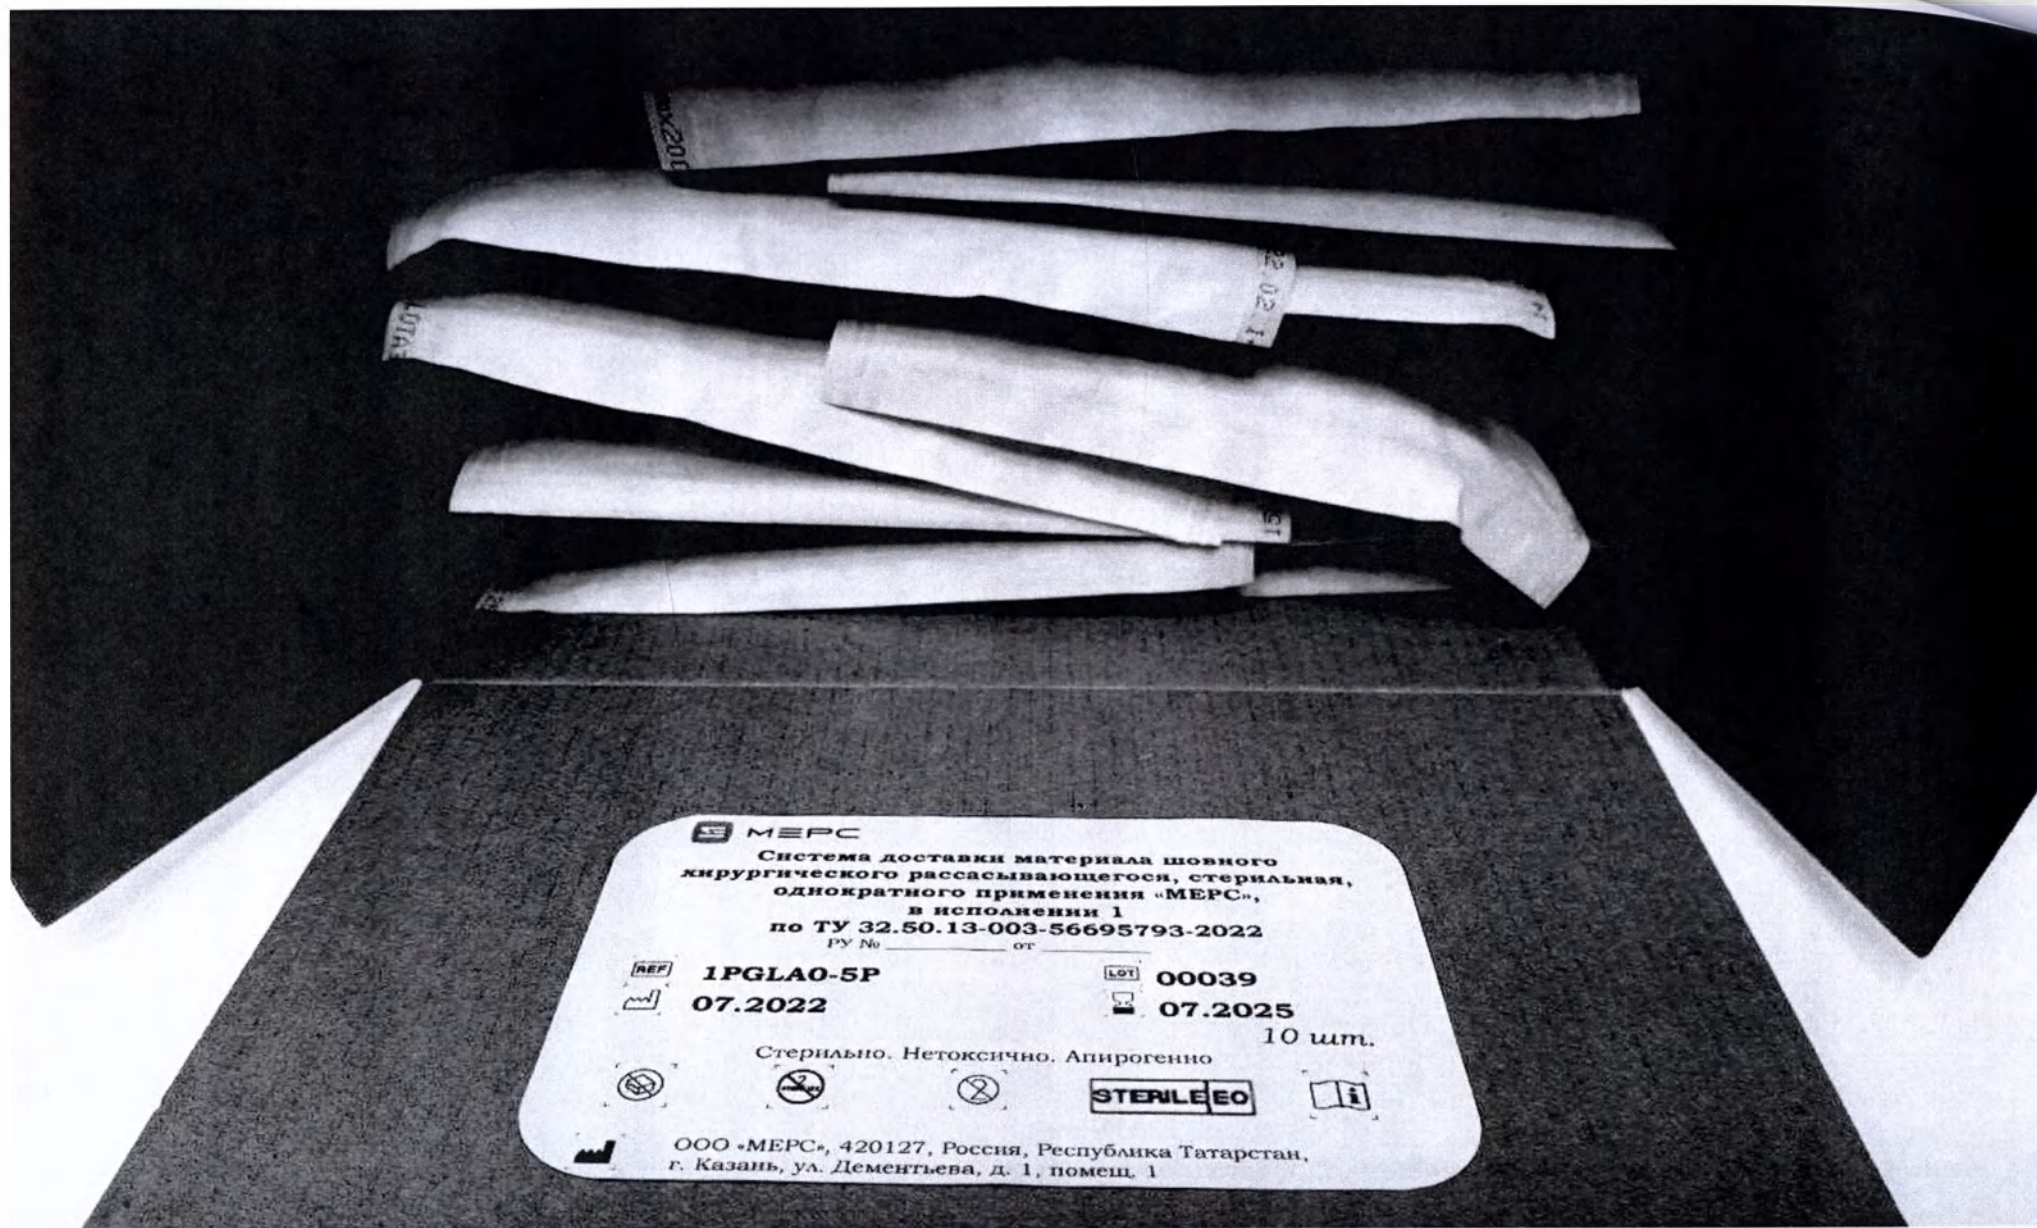


Фото 6. Пример потребительской групповой упаковки
Системы доставки материала шовного хирургического рассасывающегося, стерильной, однократного применения «MEPC»
по ТУ 32.50.13-003-56695793-2022

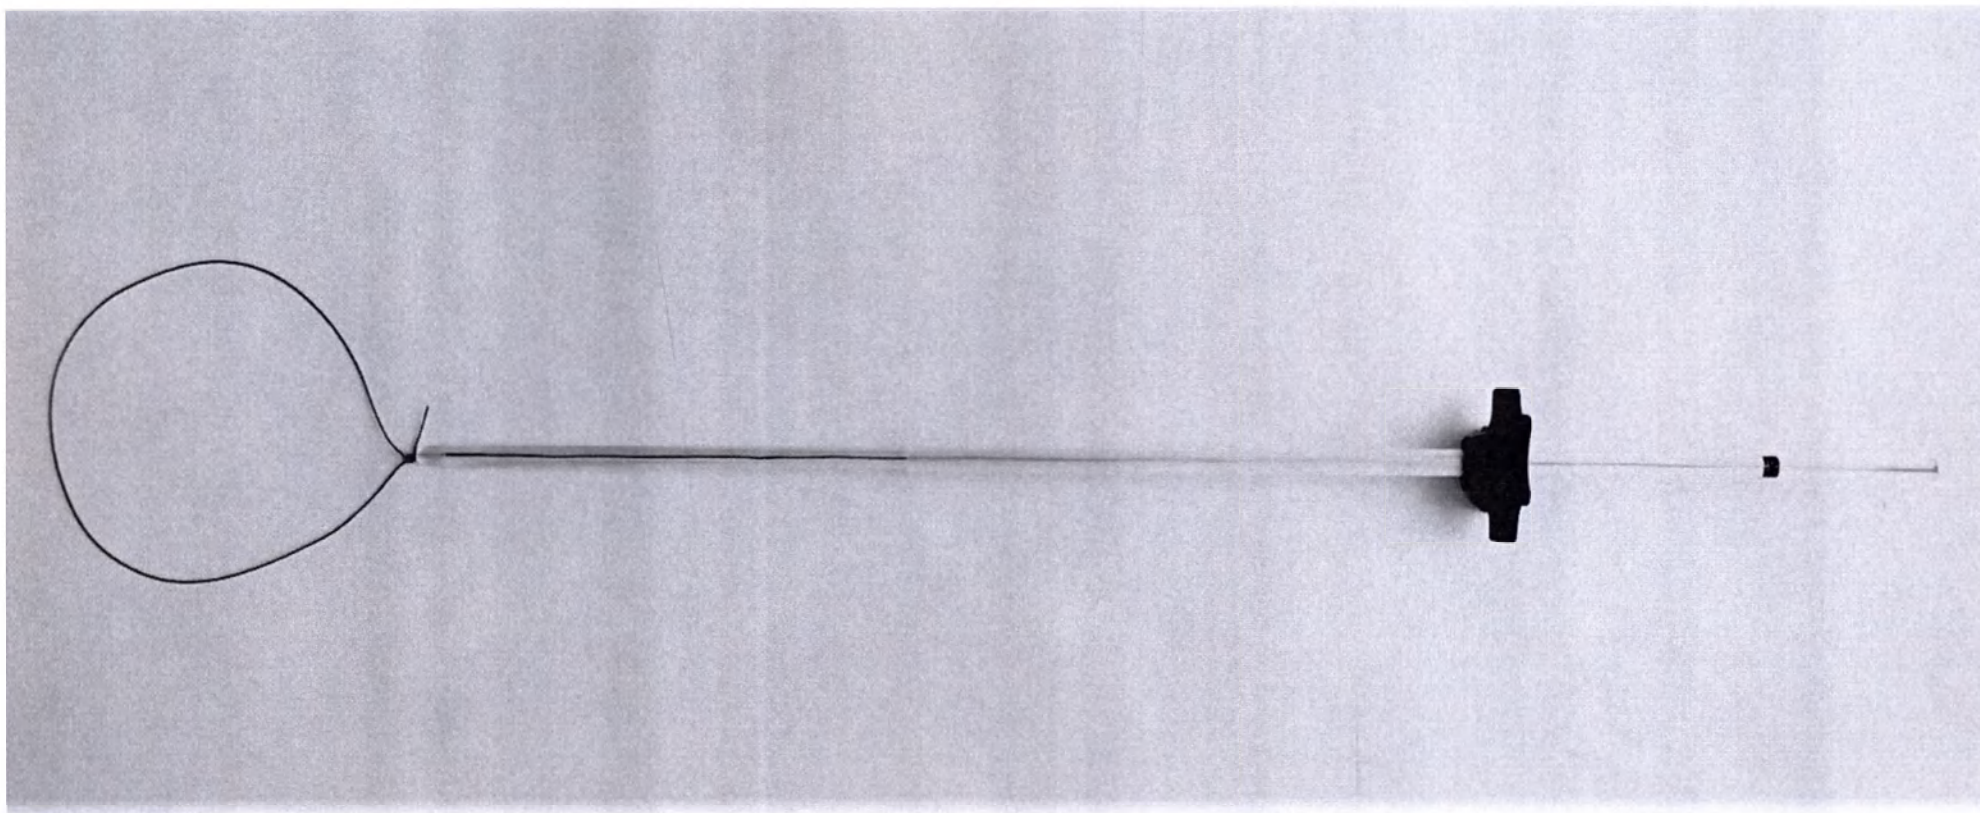


Фото 7. Система доставки материала шовного хирургического рассасывающегося, стерильная, однократного применения «МЕРС», в исполнении 1 по ТУ 32.50.13-003-56695793-2022

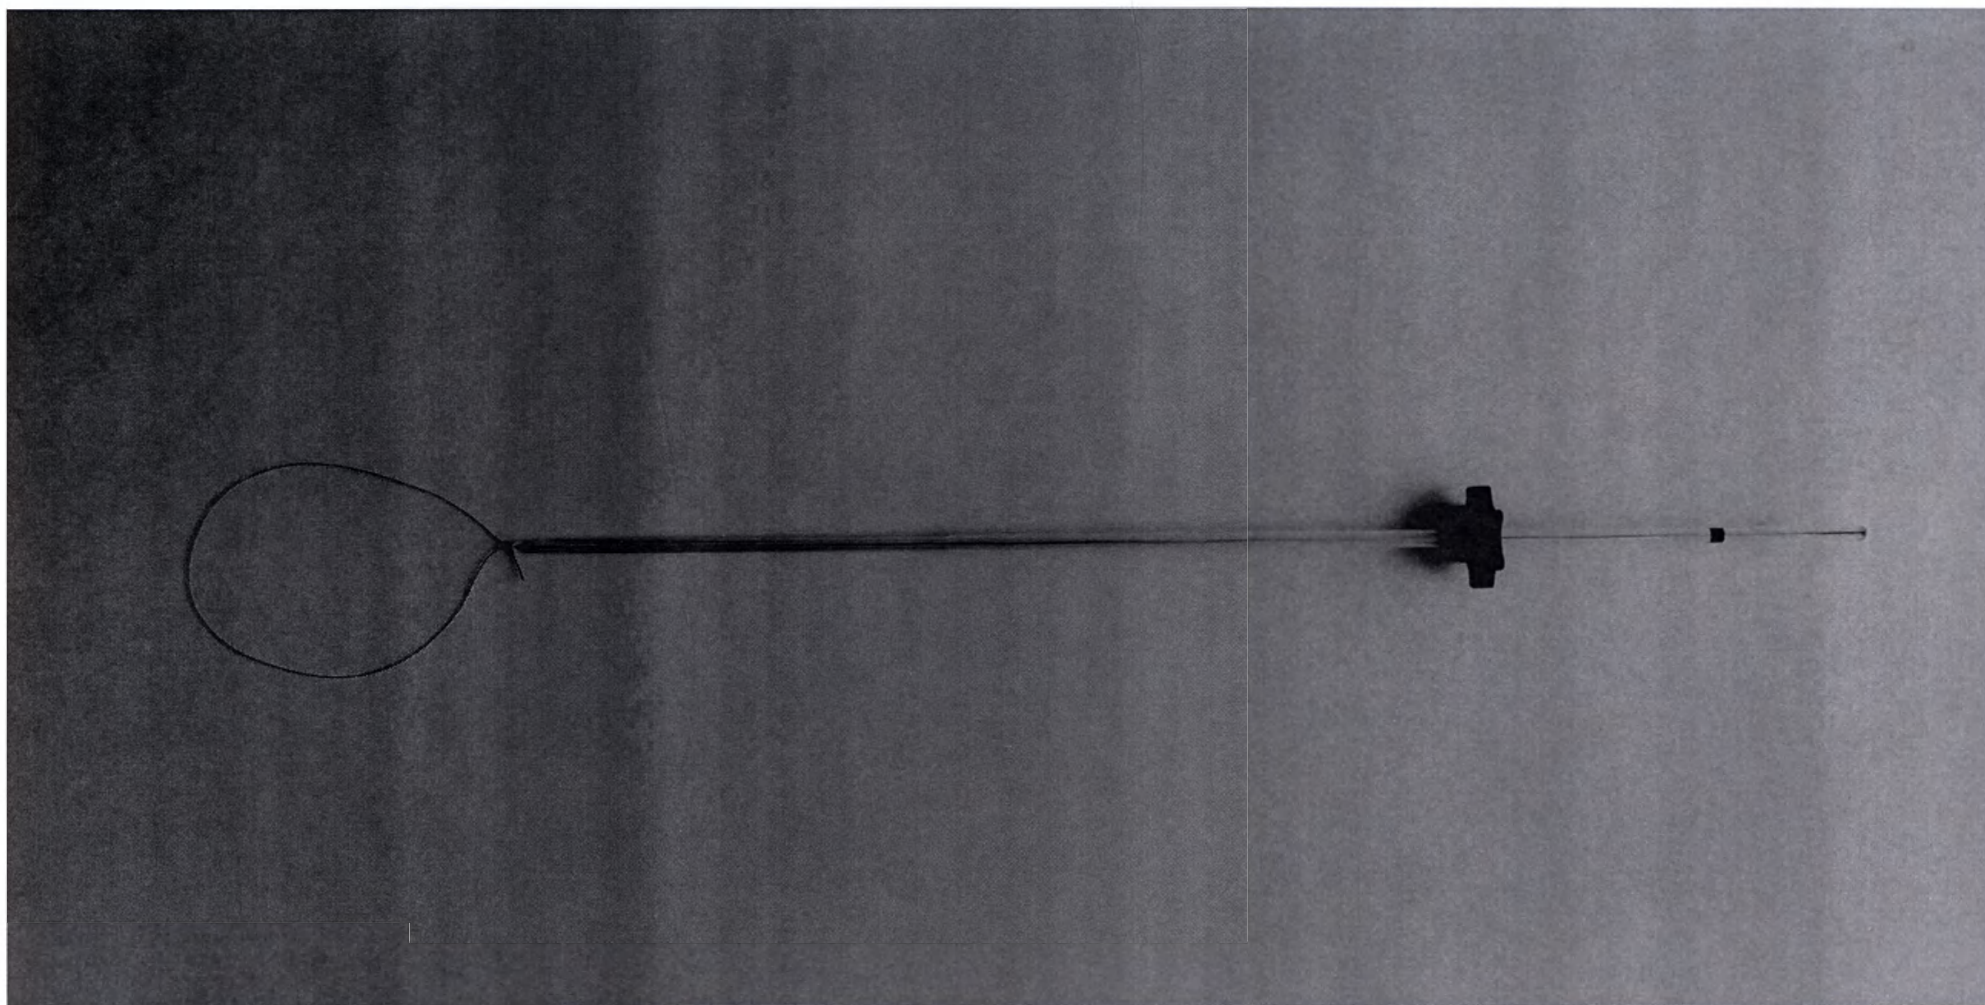


Фото 8. Система доставки материала шовного хирургического рассасывающегося, стерильная, однократного применения «МЕРС», в исполнении 2 по ТУ 32.50.13-003-56695793-2022

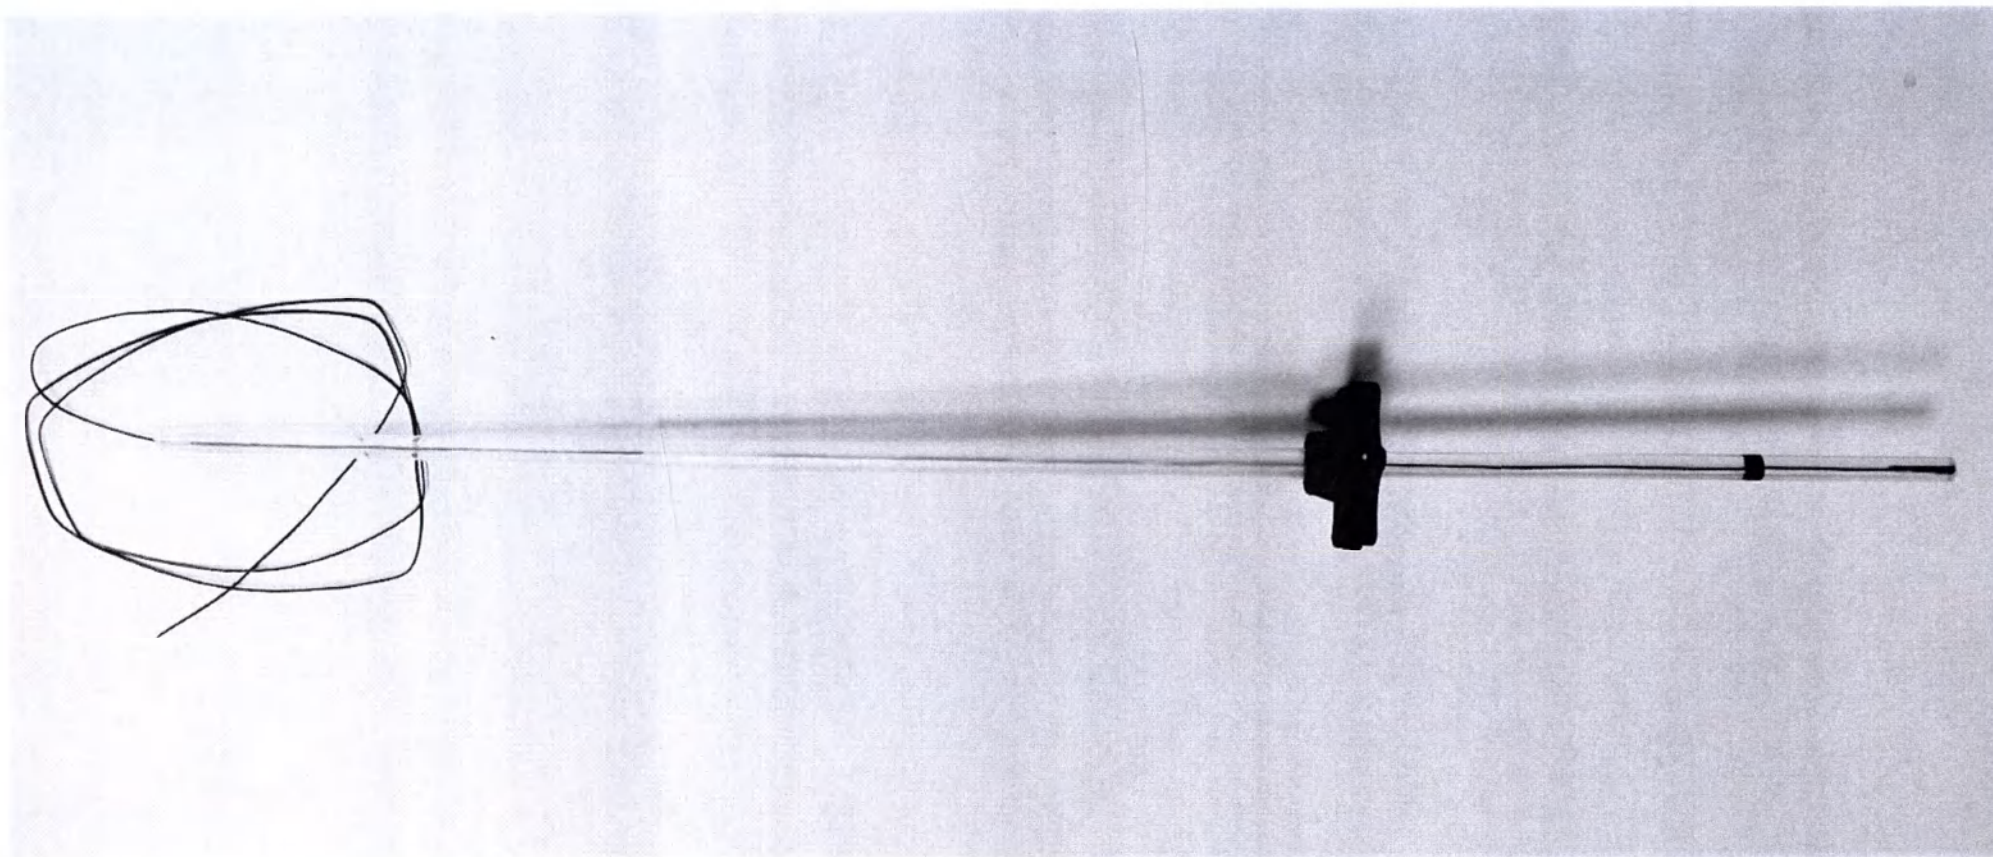


Фото 9. Система доставки материала шовного хирургического рассасывающегося, стерильная, однократного применения «МЕРС», в исполнении 3 по ТУ 32.50.13-003-56695793-2022

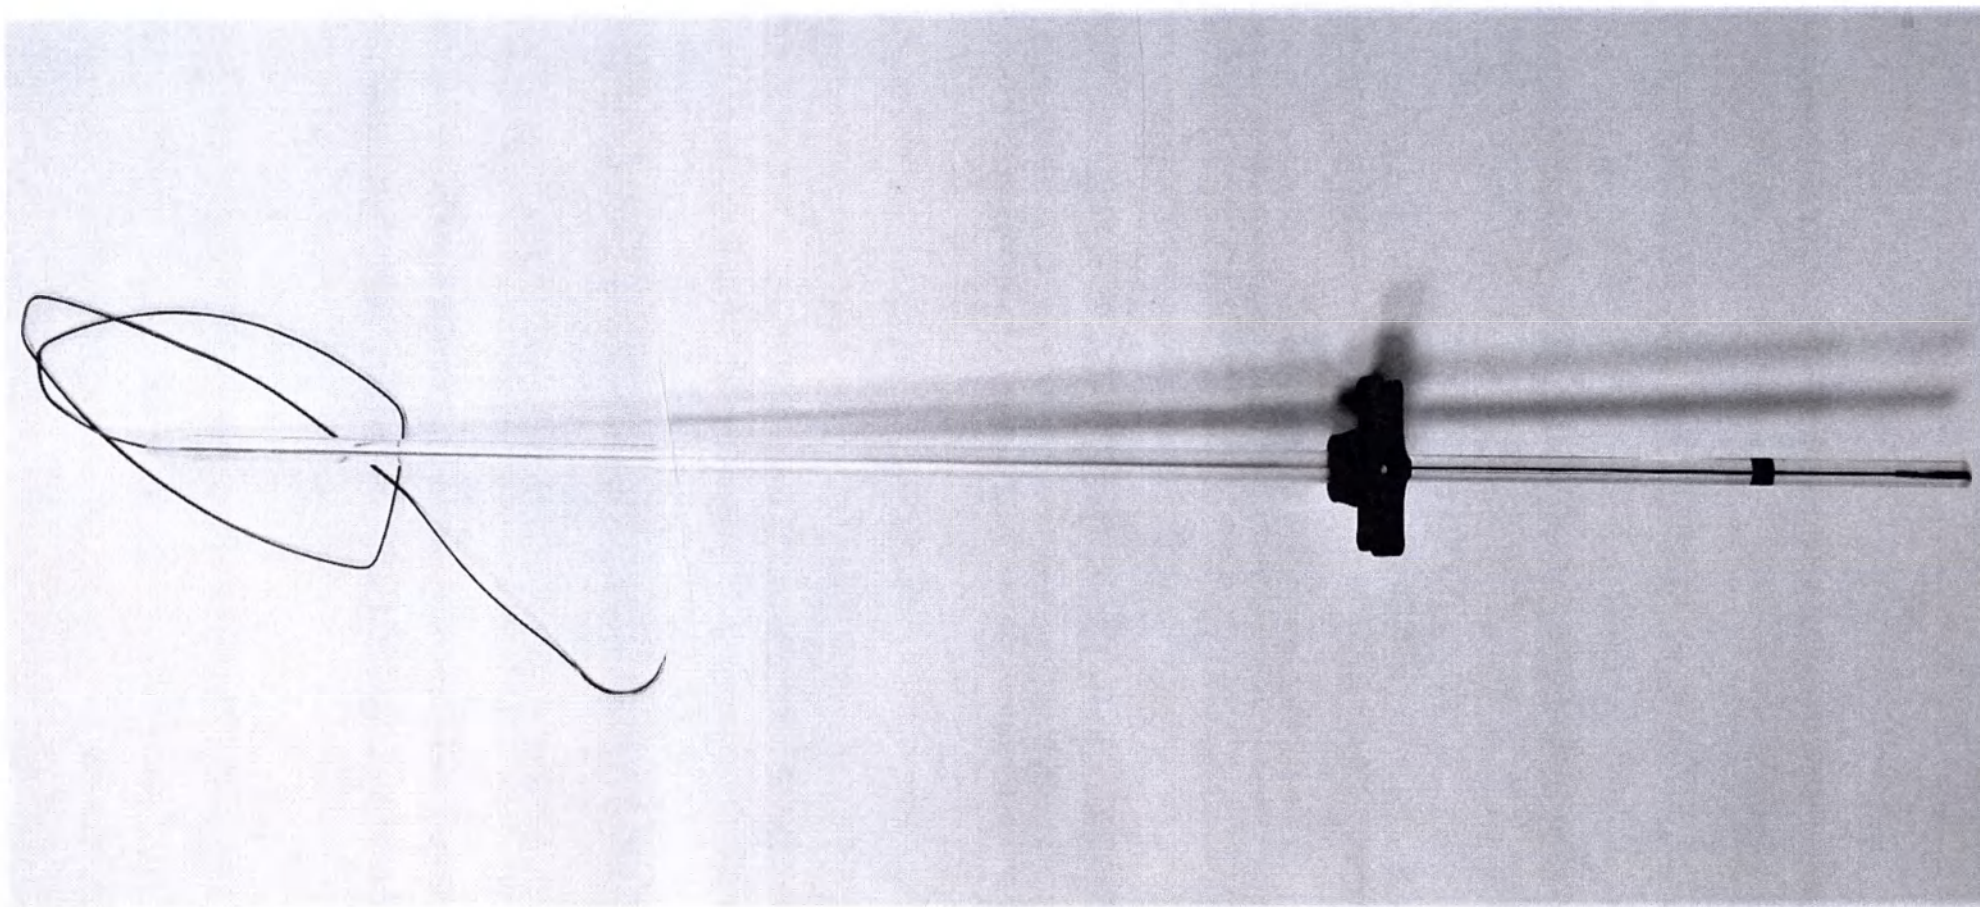


Фото 10. Система доставки материала шовного хирургического рассасывающегося, стерильная, однократного применения «МЕРС», в исполнении 4 по ТУ 32.50.13-003-56695793-2022

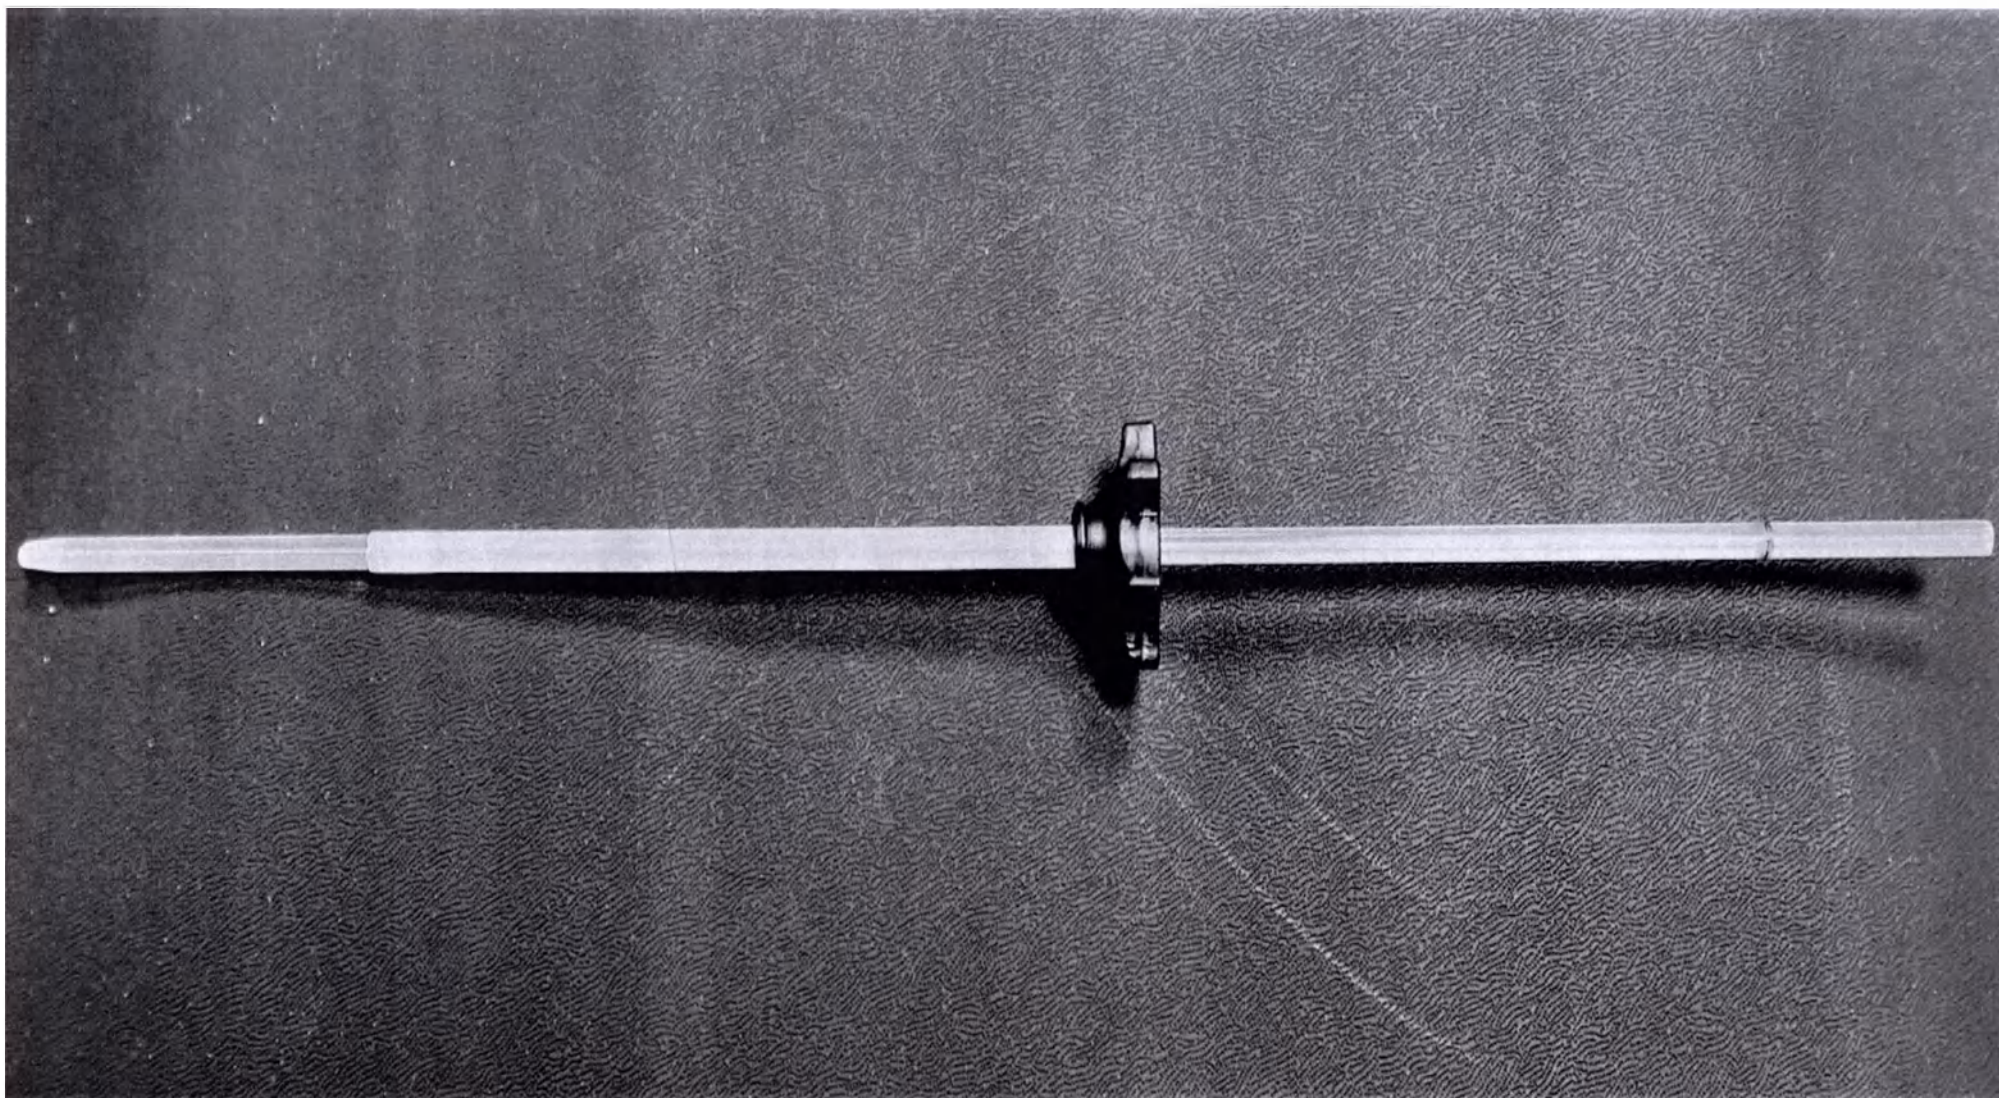


Фото 11. Система доставки материала шовного хирургического рассасывающегося, стерильная, однократного применения «МЕРС» по ТУ 32.50.13-003-56695793-2022, с пластиковым тубусом

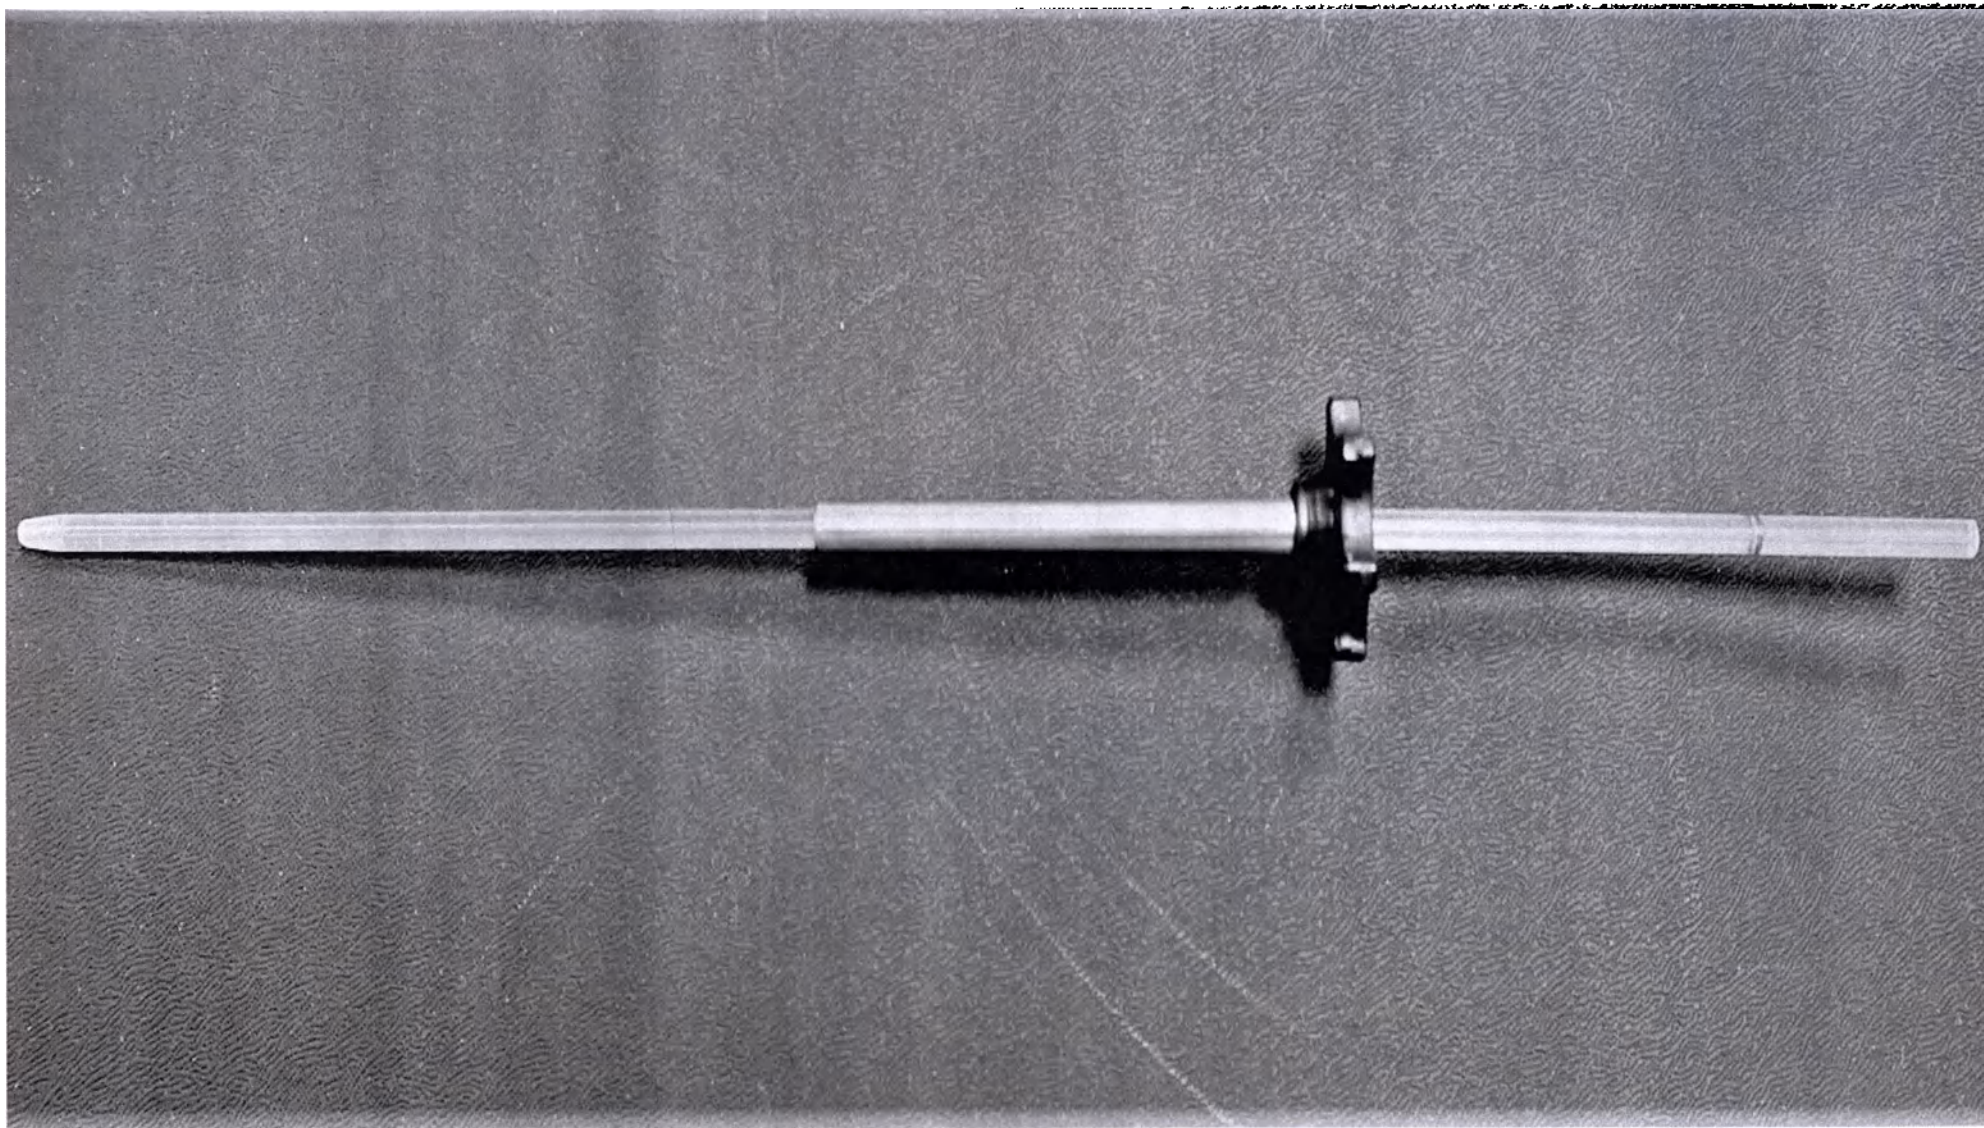


Фото 12. Система доставки материала шовного хирургического рассасывающегося, стерильная, однократного применения «МЕРС» по ТУ 32.50.13-003-56695793-2022, с металлическим тубусом

ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО

ПЕЧАТЬЮ 13 ЛИСТА(ОВ)

ДИРЕКТОР

ООО «МЕРС»

ВОЛЧЕНКО В.В.

