

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Набор реагентов для количественного определения холестерина ЛПВП методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas с и COBAS INTEGRA (HDLC4), в вариантах исполнения

производства Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany



Вариант 1. Реагенты во флаконах (HDL C4/HDL Cholesterol Gen.4 cobas c 111), 2x100 тестов

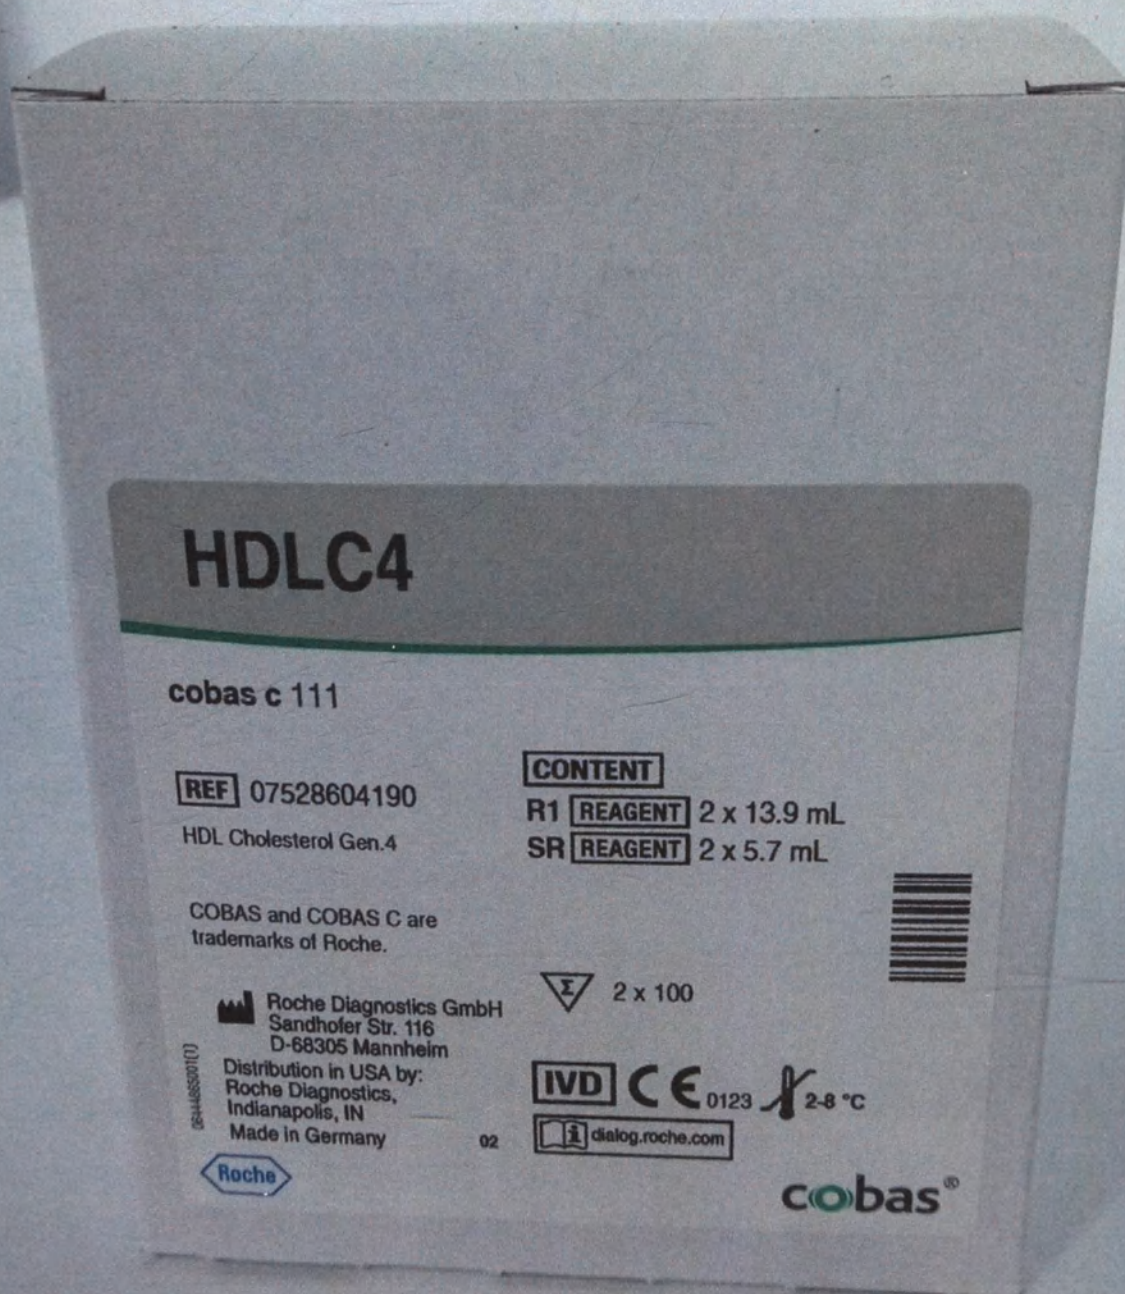

Матрица $\mathbf{A}$ имеет вид $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$. Найдем ее обратную матрицу $\mathbf{A}^{-1}$.

1. Ригор РІ 30 μ м, 2 тун.
2. Ригор SR 30 μ м, 2 тун.
3. Методика по референсу

Click to register in my name

How much of a year's

The new system checks the

Marshall, Gary, Representative

Managers responsible for the design and development of new products should be aware of the importance of the design and development process in the success of a new product. The design and development process is a critical part of the product lifecycle, and it is essential to ensure that the process is well-managed and controlled. This involves a number of factors, including the selection of the right team, the establishment of clear goals and objectives, and the implementation of a robust design and development process. By following these principles, managers can ensure that their new products are designed and developed in a way that maximizes their chances of success in the market.

For more valuable information, request your free report today. Call 800-368-5868.

TRANSACTIONS OF THE AMERICAN PHYSIOLOGICAL SOCIETY, 1951

U.S. Tel: +7 495 229-69-99, Fax: +7 495 229-63-84

Email: marketing@reception.de

800.746.6622

REF (240)07528604190

GTIN (01)04015630942589

LOT (10)66934101

2024-03-31

2022-07-27



04



Вариант 1. Реагенты во флаконах (HDL C4/HDL Cholesterol Gen.4 cobas c 111), 2x100 тестов, в составе (Маркировка на русском языке)

HDL C4

REF (240)07528604190
GTIN (01)04015630942589

Набор реагентов для количественного определения холестерина ЛПВП методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas с и COBAS INTEGRA (HDL C4), в вариантах исполнения:

Вариант 1 Реагенты во флаконах (HDL C4/HDL Cholesterol Gen 4 cobas c 111), 2x100 тестов, в составе:

- 1 Реагент R1 во флаконе, 2 шт.;
- 2 Реагент SR во флаконе, 2 шт.;
- 3 Инструкция по применению

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7357 от 27.06.2022

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диагностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностика Рус» (ООО «Рох Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д 2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64 E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 07528604190

Вариант 1. Реагенты во флаконах (HDLC4/HDL Cholesterol Gen.4 cobas c 111), 2x100 тестов, составе:
1. Реагент R1 во флаконе, 2 шт.




Вариант 1. Реагенты во флаконах (HDLC4/HDL Cholesterol Gen.4 cobas c 111), 2x100 тестов, составе:

1. Реагент R1 во флаконе, 2 шт.



Вариант 1. Реагенты во флаконах (HDL C4/HDL Cholesterol Gen.4 cobas c 111), 2x100 тестов, в составе:

2. Реагент SR во флаконе, 2 шт.

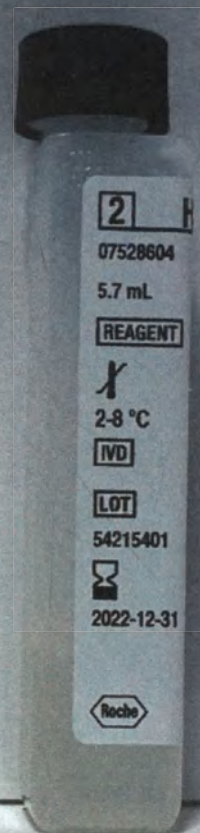

Вариант 1. Реагенты во флаконах (HDLC4/HDL Cholesterol Gen.4 cobas c 111), 2x100 тестов, в составе:

2. Реагент SR во флаконе, 2 шт.



Вариант 1. Реагенты во флаконах (HDLc4/HDL Cholesterol Gen.4 cobas c 11), 2x100 тестов, в составе:

2. Реагент SR во флаконе, 2 шт



B
HDLC4

HDL-Cholesterol Gen.4
COBAS INTEGRA / cobas c systems

REF 07528566190

System-ID 07 7589 4

CONTENT  350

 2-8 °C

IVD

 dialog.roche.com

 **0123**

COBAS C, COBAS INTEGRA and
COBAS are trademarks of Roche.



 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
Made in Germany

02

cobas[®]

04432002001(3)


HDLC4

REF (240)07528566190

For USA: Rx only



2024-09-30



2022-12-14



For USA: Store upright

UDI



EU: +800 5505 6606
USA: +1 800 4282336

LOT (10)67452101

GTIN (01)04015630942565


Roche

04

Ser.No. 20327

HDLC4 07528566 190

02

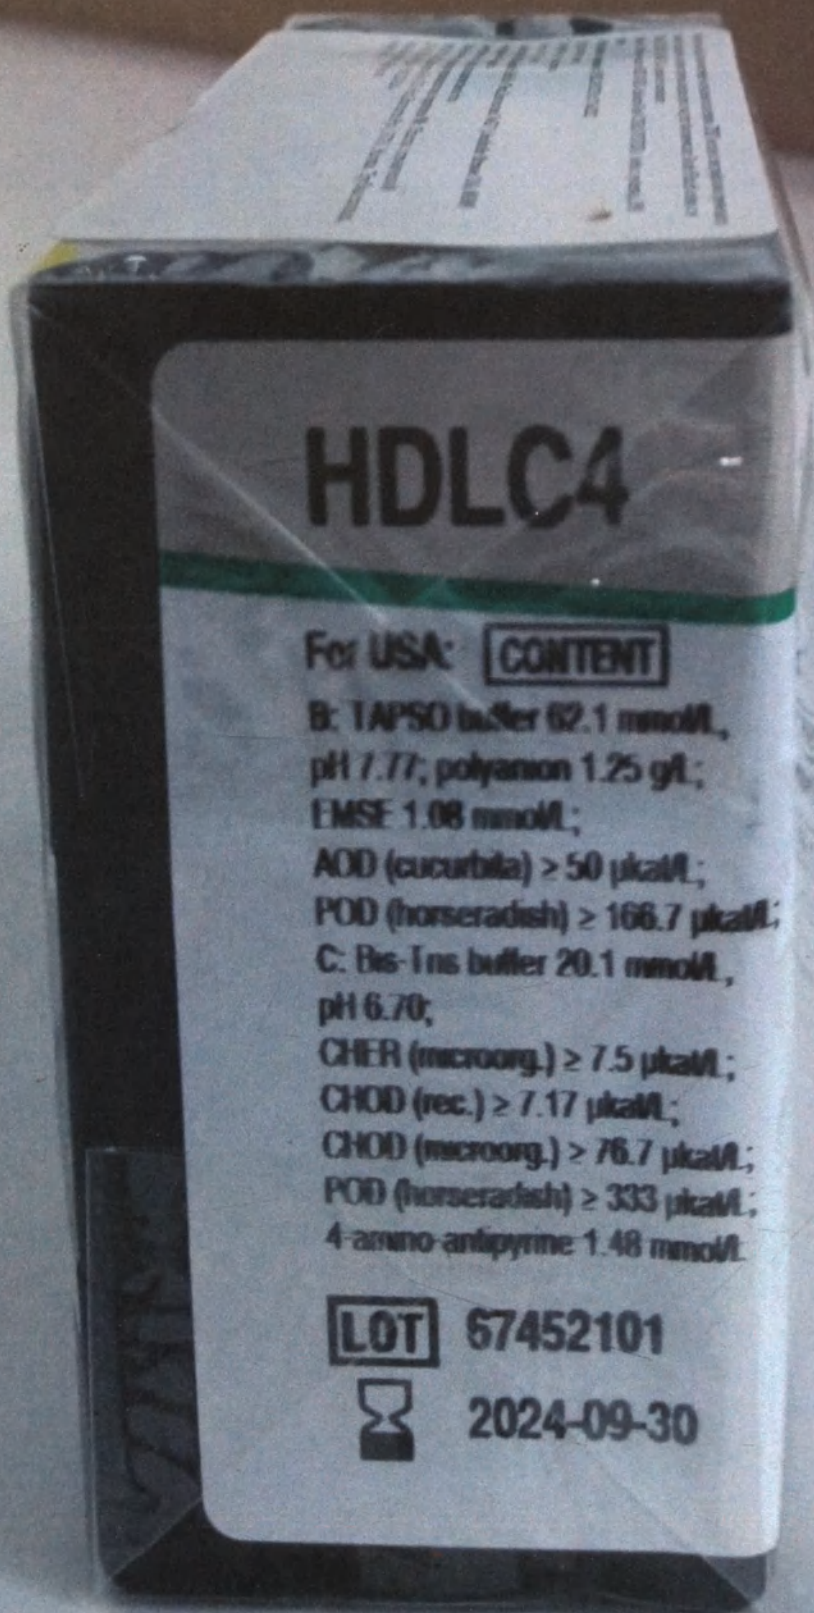

Вариант 2. Реагенты в кассете (HDLc4/HDL-Cholesterol Gen.4 COBAS INTEGRA / cobas c systems), 350 тестов (Маркировка на русском языке)

Набор реагентов для количественного определения холестерина ЛПВП методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c и COBAS INTEGRA (HDLc4), в вариантах исполнения:

Вариант 2. Реагенты в кассете (HDLc4/HDL-Cholesterol Gen.4 COBAS INTEGRA / cobas c systems), 350 тестов.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7357 от 27.06.2022

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 07528566190

Вариант 3. Реагенты в кассете (HDLc4/HDL-Cholesterol Gen.4 cobas c systems), 500 тестов



Вариант 3. Реагенты в кассете (HDL C4/HDL-Cholesterol Gen.4 cobas c systems), 500 тестов



Вариант 3. Реагенты в кассете (HDLC4/HDL-Cholesterol Gen.4 cobas c systems), 500 тестов



Вариант 3. Реагенты в кассете (HDLC4/HDL-Cholesterol Gen.4 cobas c systems), 500 тестов
(Маркировка на русском языке)

Набор реагентов для количественного определения холестерина ЛПВП методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c и COBAS INTEGRA (HDLC4), в вариантах исполнения: Вариант 3. Реагенты в кассете (HDLC4/HDL-Cholesterol Gen.4 cobas c systems), 500 тестов
Регистрационное удостоверение № P3H 2014/7357 от 27.06.2022

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д. 2. Тел. +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 07528582190

Вариант 4. Реагенты в кассете (HDLc4/HDL-Cholesterol Gen.4 cobas c systems), 700 тестов

B
HDLc4

C

HDL-Cholesterol Gen.4
cobas c systems

REF 08057877190

System-ID 20 7100 1


CONTENT 700

2-8 °C

IVD

dialog.roche.com

COBAS and COBAS C
are trademarks of Roche.



CE 0123

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
Made in Germany

02
cobas[®]

0443200201(3)

Вариант 4. Реагенты в кассете (HDLc4/HDL-Cholesterol Gen.4 cobas c systems), 700 тестов

HDLc4


REF (240)08057877190

For USA: Rx only

LOT (10)57273701

 2023-07-31

 2021-11-25



For USA: Store upright



EU: +800 5505 6606
USA: +1 800 4282336

UDI



GTIN (01)07613336121306



03

HDLc4

For USA: **CONTENT**

B: TAPSO buffer 62.1 mmol/L,

pH 7.77; polyanion 1.25 g/L;

EMSE 1.08 mmol/L;

AOD (cucurbita) $\geq 50 \mu\text{kat/L}$;

POD (horseradish) $\geq 166.7 \mu\text{kat/L}$;

C: Bis-Tris buffer 20.1 mmol/L,

pH 6.70;

CHER (microorg.) $\geq 7.5 \mu\text{kat/L}$;

CHOD (rec.) $\geq 7.17 \mu\text{kat/L}$;

CHOD (microorg.) $\geq 76.7 \mu\text{kat/L}$;

POD (horseradish) $\geq 333 \mu\text{kat/L}$;

4-amino-antipyrine 1.48 mmol/L

LOT 57273701



2023-07-31

Набор реагентов для количественного определения холестерина ЛПВП методом спектрофотометрического анализа в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c и COBAS INTEGRA (HDLc4), в вариантах исполнения:
Вариант 4. Реагенты в кассете (HDLc4/HDL-Cholesterol Gen.4 cobas c systems), 700 тестов
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7357 от 27.06.2022

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диагностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностика Рус» (ООО «Рох Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64 E-mail: moscow_reception_dia@roche.com

Кат. номер 08057877190

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

22 листа (ов)

Светлова И. Т.



по договору № 143/2023
от 30.01.2023 г.