

Светодиодная индикация разряда батареи.

Многоуровневая система защиты пациента.

3. Комплект поставки аппарата

3.1. Аппарат «ДОКТОР ТЭС - 03», шт.	1
3.2. Электроды, комплект.	1
3.3. Прокладки, комплект из трех штук.	1
3.4. Руководство по эксплуатации с инструкцией по применению, шт.	1
3.5. Упаковка, шт.	1
3.6. Батарея типа «Крона».....	1

Примечание: Возможно использование аккумуляторной батареи типа «Крона» с внешним зарядным устройством (приобретаются отдельно).

4. Внешний вид аппарата и органы управления

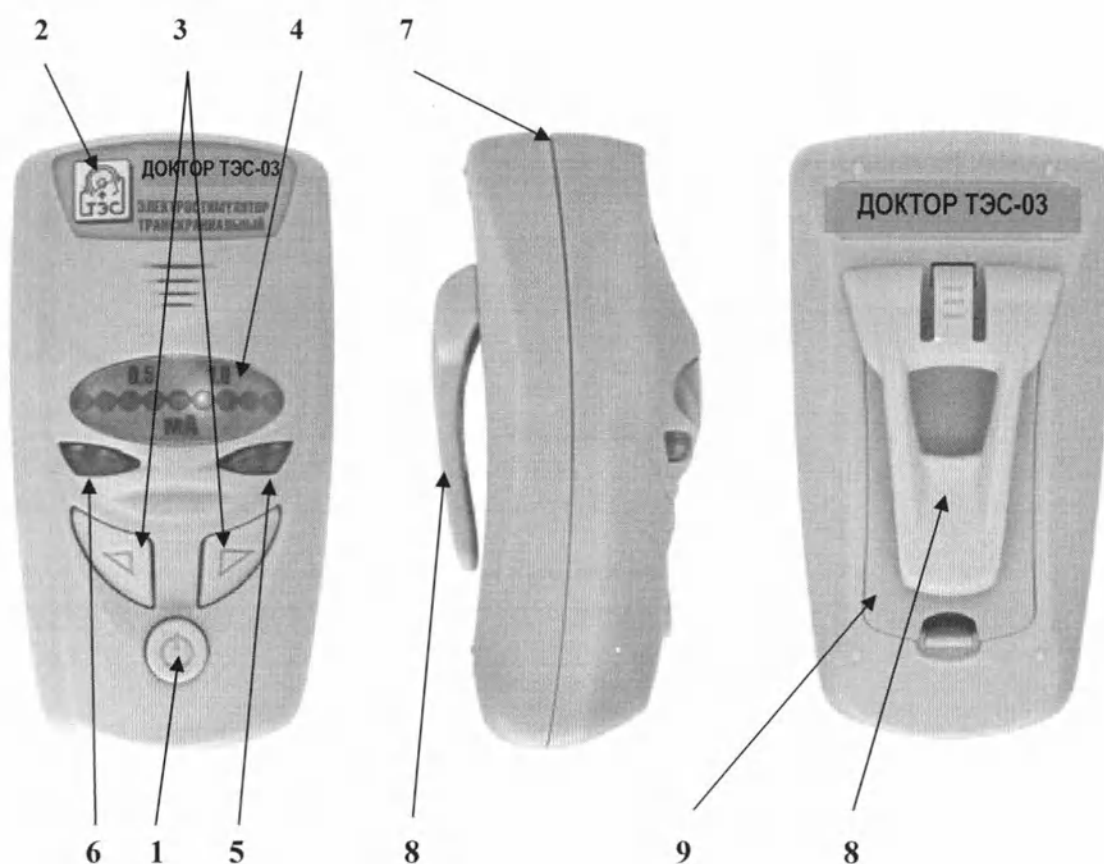


Рис. 1. Органы управления и индикации аппарата (см. Таблицу 1).