

SCHILLER

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «ШИЛЛЕР.РУ»

Казанчян Карен Петросович



Казанчян К.П.

2023 г.


Фотографические изображения медицинского изделия

Система мониторинга пациента во время магнитно-резонансной томографии
MAGLIFE RT-1, в вариантах исполнения

2023



1. Монитор пациента в условиях МРТ MAGLIFE RT-1

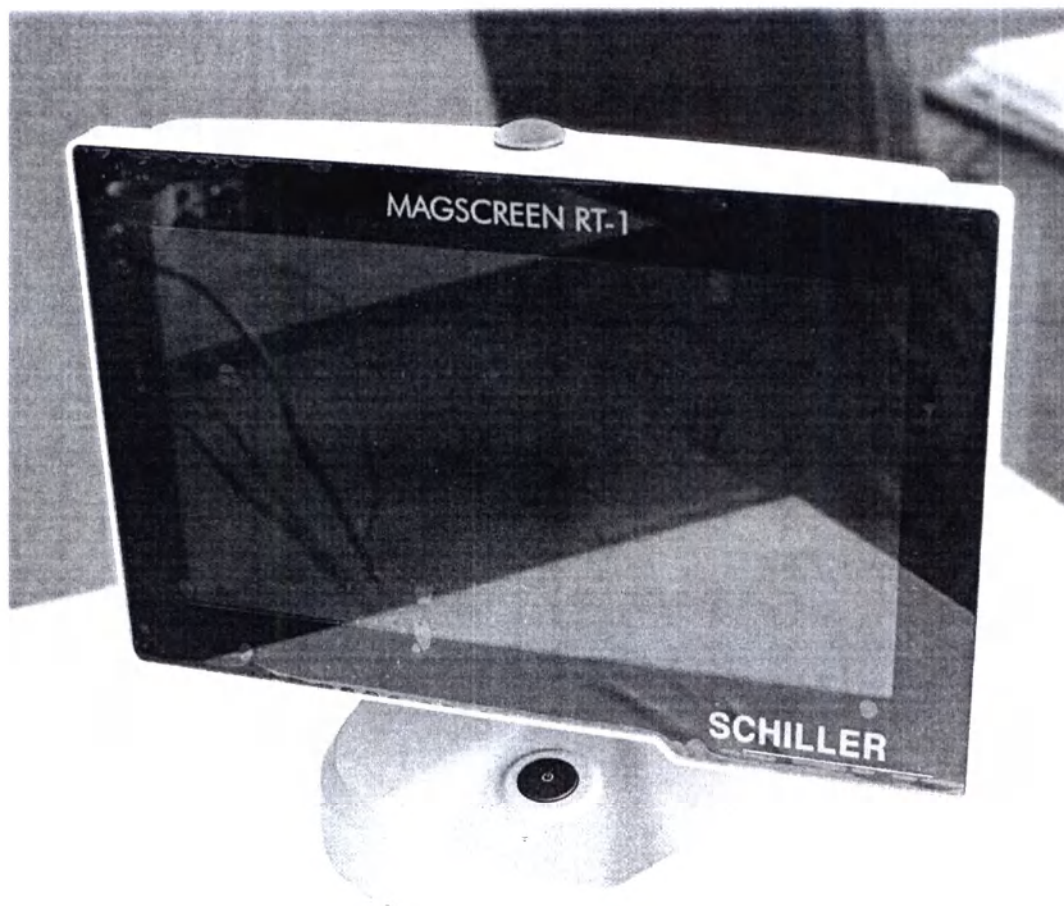


2. Ретранслирующий экран (монитор) MAGSCREEN RT-1



3. Соединительное устройство MAGLINK для системы MAGLIFE /
MAGSCREEN




4. Электроды ЭКГ для взрослых/детей с весом > 3 кг , одноразовые

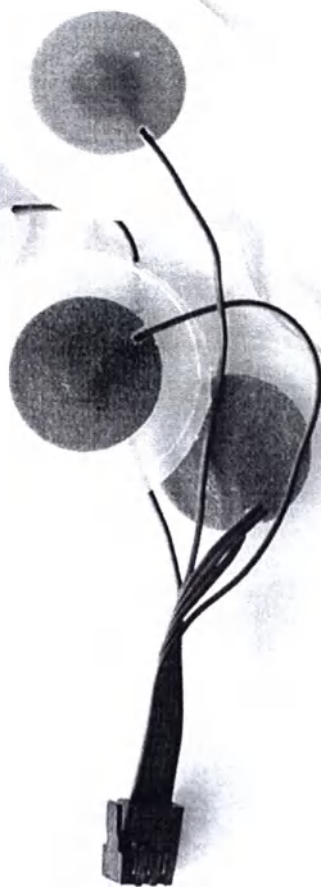

5. Электроды ЭКГ для новорожденных с весом < 5 кг, одноразовые




6. Беспроводной датчик ЭКГ

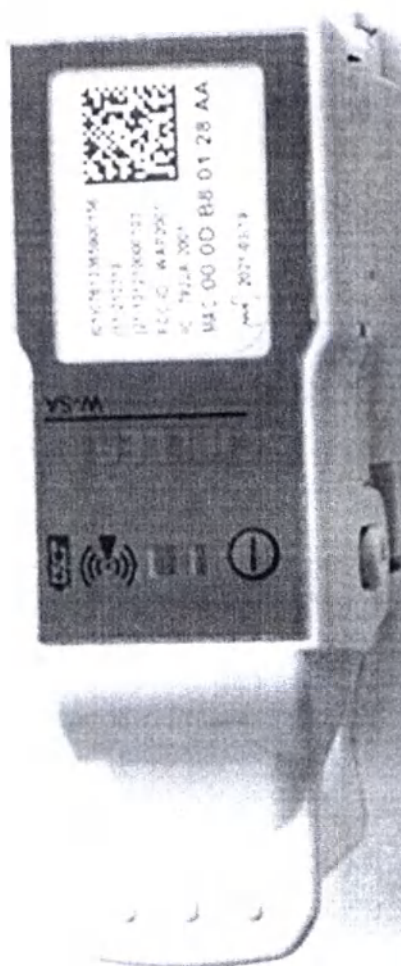

7. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для взрослых тип W-SA



8. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для детей тип W-SP

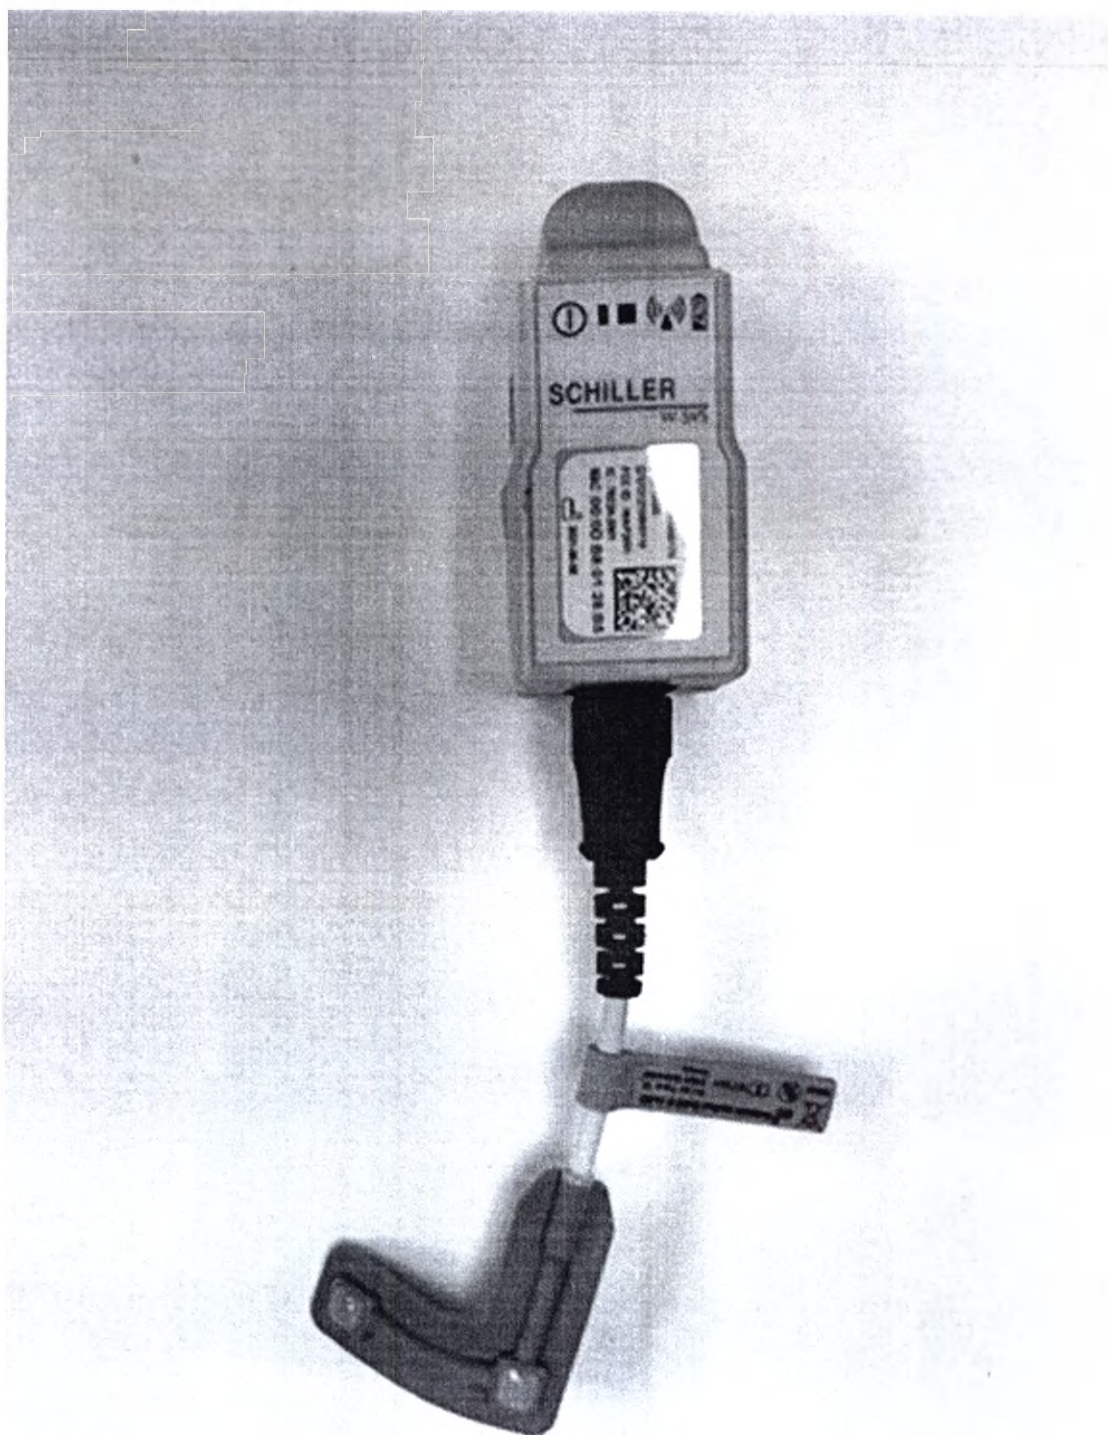

9. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для детей тип W-SVS (для очень маленьких детей)




10. Мягкие ремешки для очень маленьких датчиков SpO2, одноразовые



11. Манжета для новорожденных мягкая, 2.5 см, одноразовая



12. Манжета для новорожденных мягкая, 4 см, одноразовая

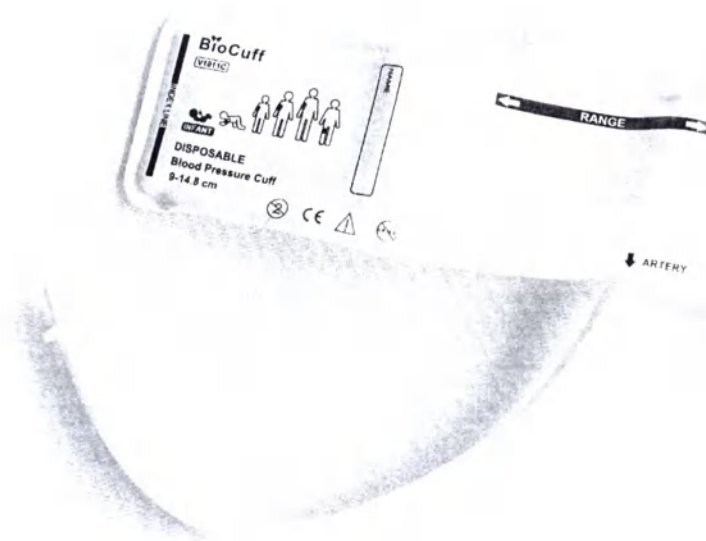

13. Манжета для новорожденных мягкая, 6 см, одноразовая



14. Манжета для детей, 8 см




15. Манжета для детей, 10 см




16. Манжета для взрослых, 14 см





17. Манжета для взрослых, 17 см

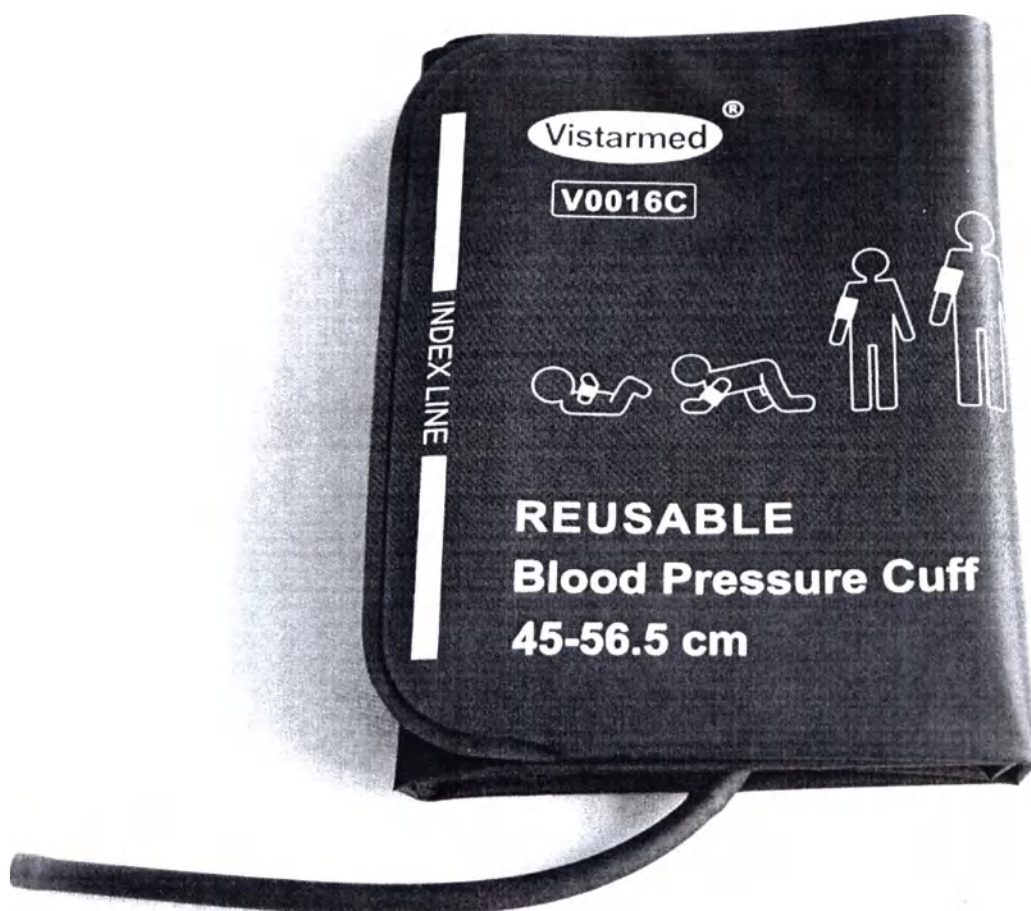

18. Манжета для взрослых, 20 см

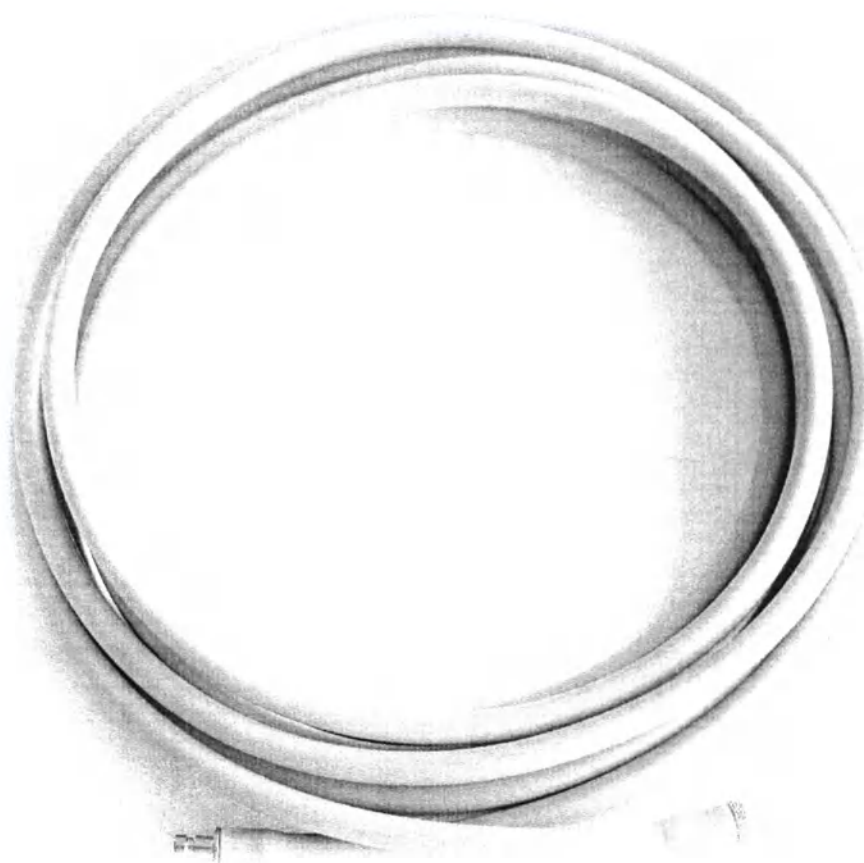

19. Трубка манжеты, 5 м

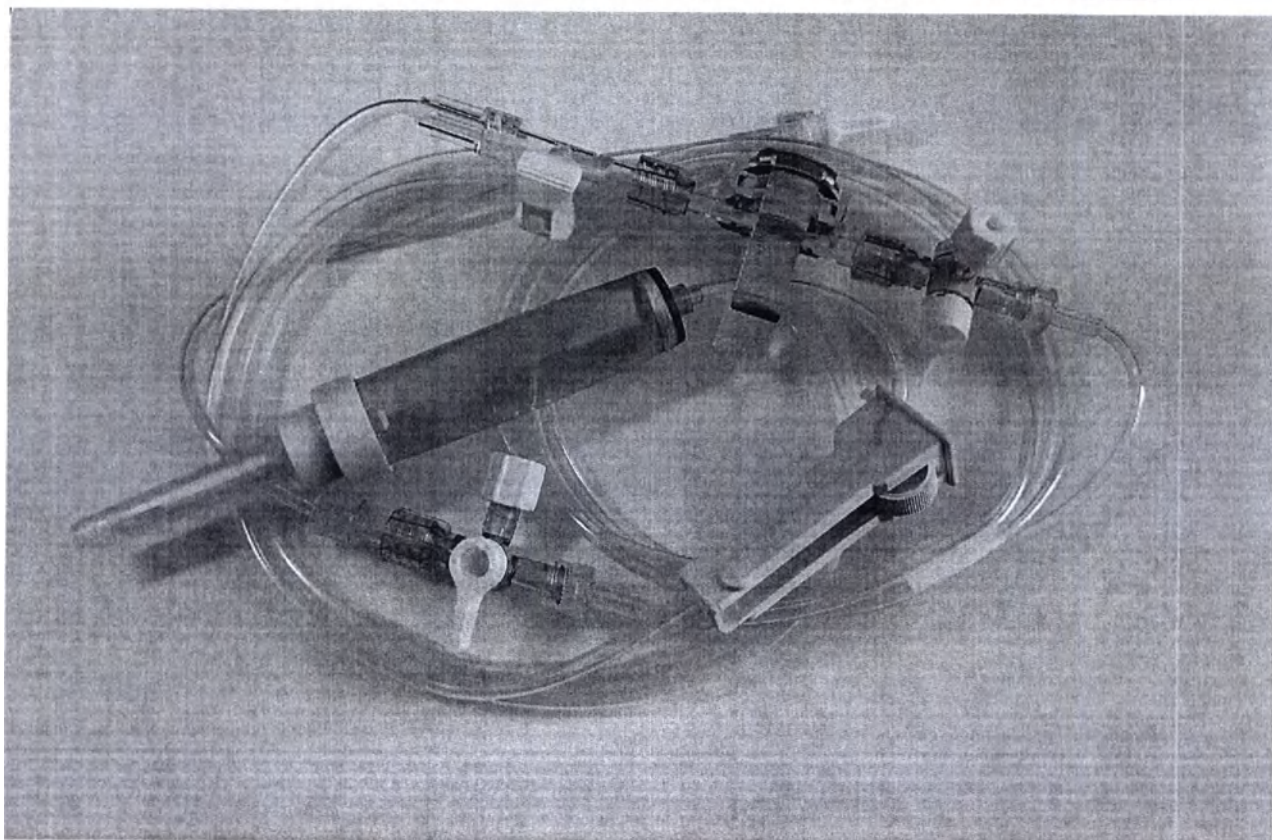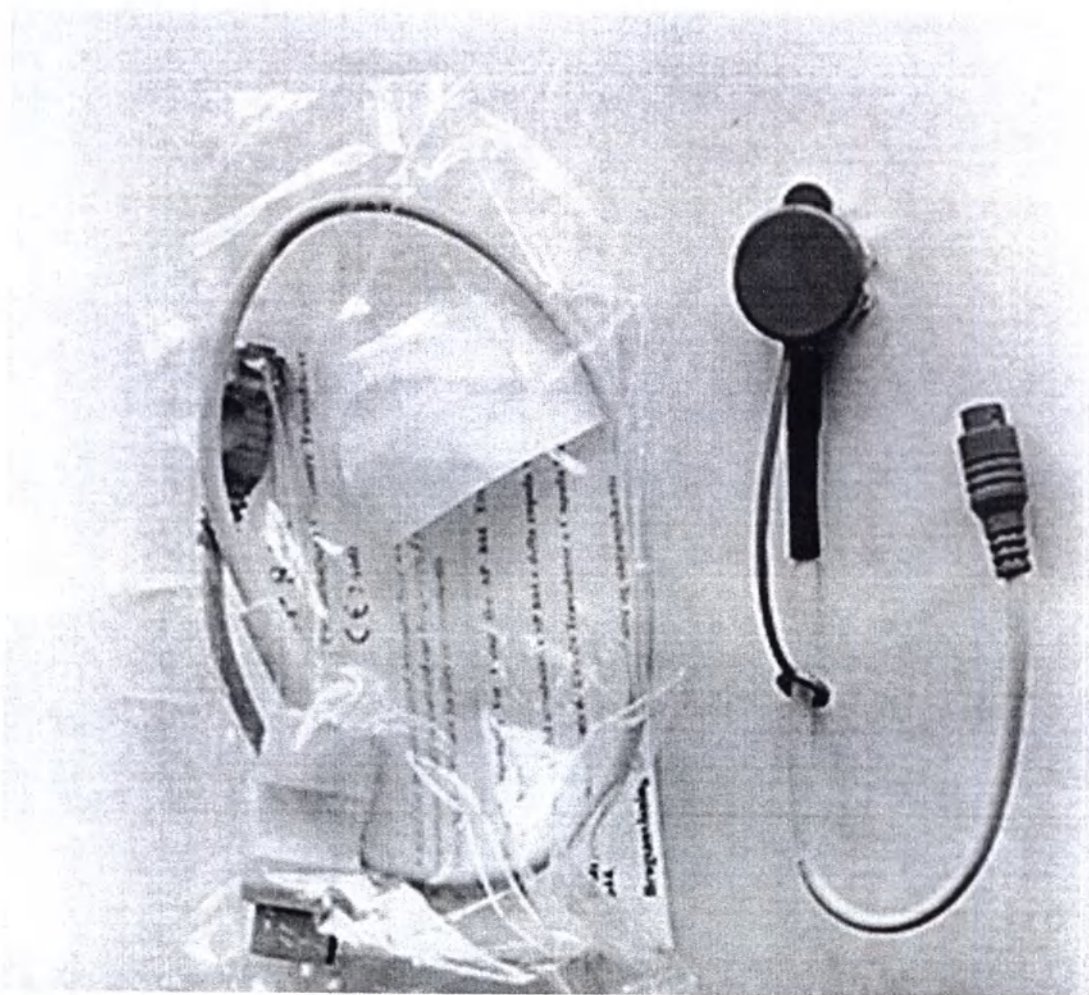

20. Комплект, состоящий из многоразового датчика "SENSOROR", кабеля адаптера и 5 одноразовых трубок давления



21. Т-образный адаптер дыхательных путей, одноразовый



22. Адаптер дыхательных путей 90°, одноразовый



23. Пробоотборная трубка CO2 для взрослых/детей 3,0 м, одноразовая




24. Пробоотборная трубка CO2 для новорожденных 3,0 м, одноразовая



25. Водяная ловушка для взрослых/детей




26. Водяная ловушка для новорожденных

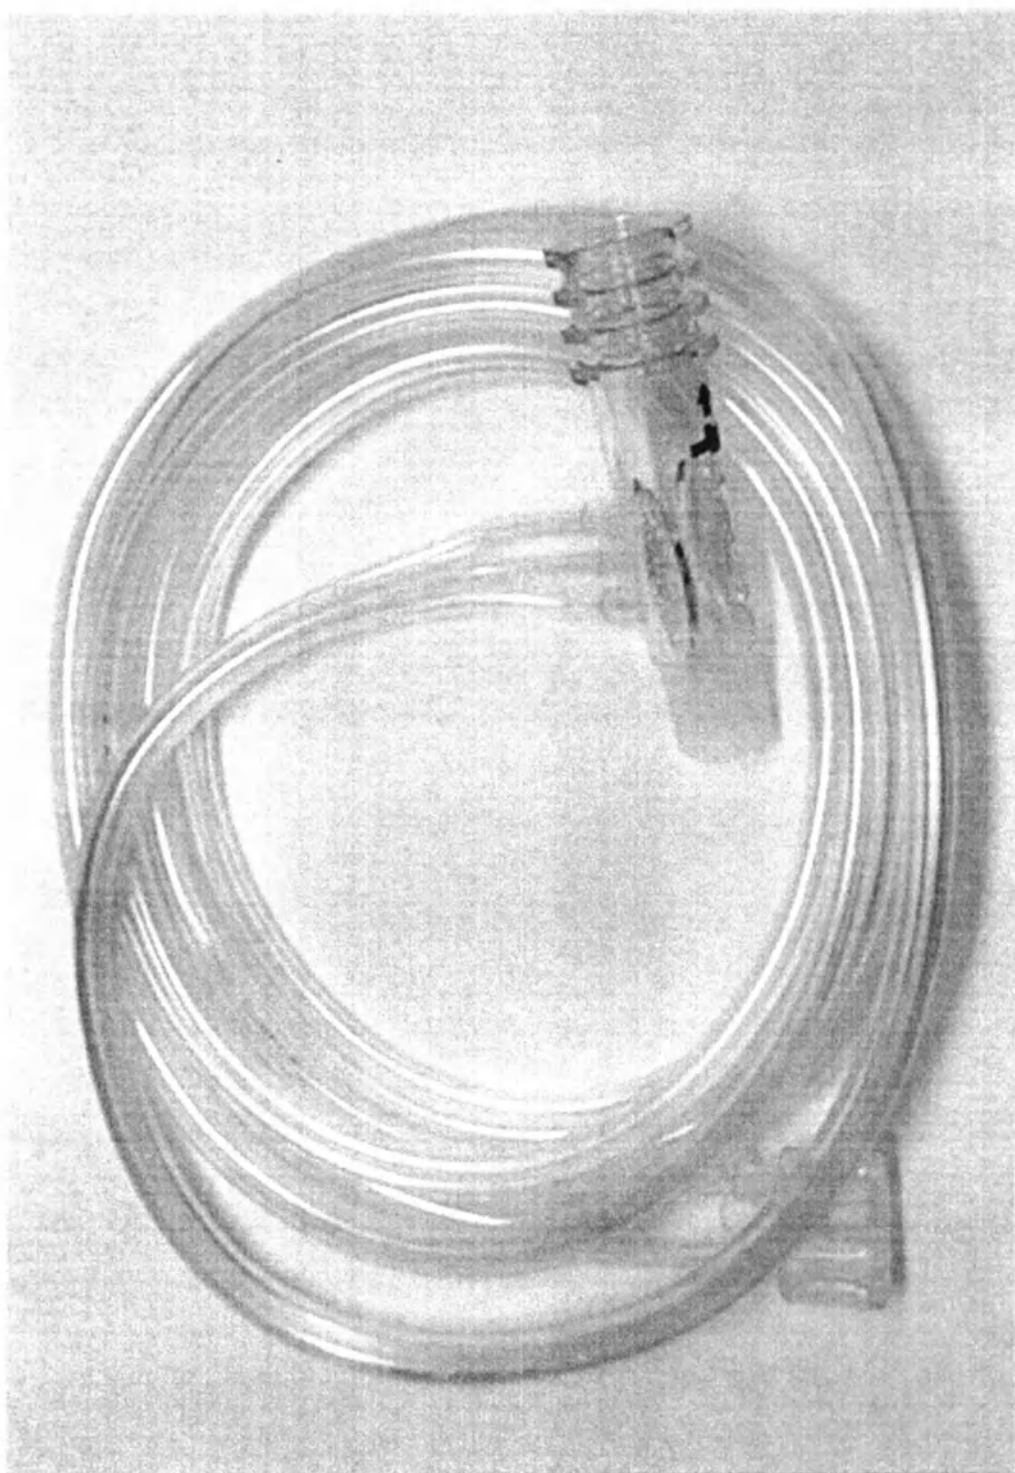


27. Датчик потока SPIRIT, для взрослых/детей, 2.5 м, с пробоотборной трубкой, одноразовый



28. Датчик потока SPIRIT, для детей/новорожденных, 2.5 м, с пробоотборной трубкой, одноразовый

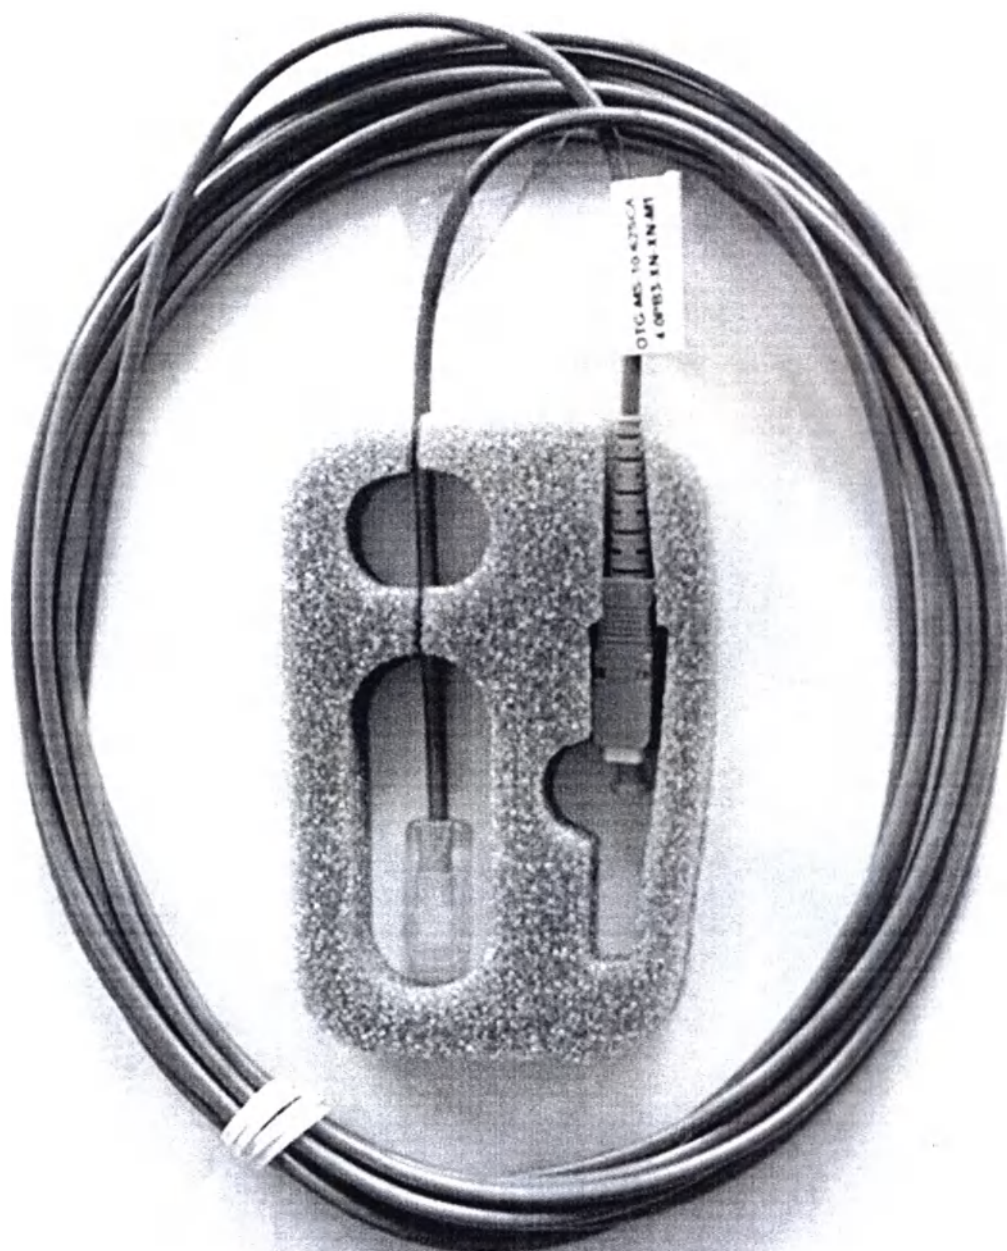

29. Температурный датчик, использующий оптический принцип измерения, для наружного/кожного применения

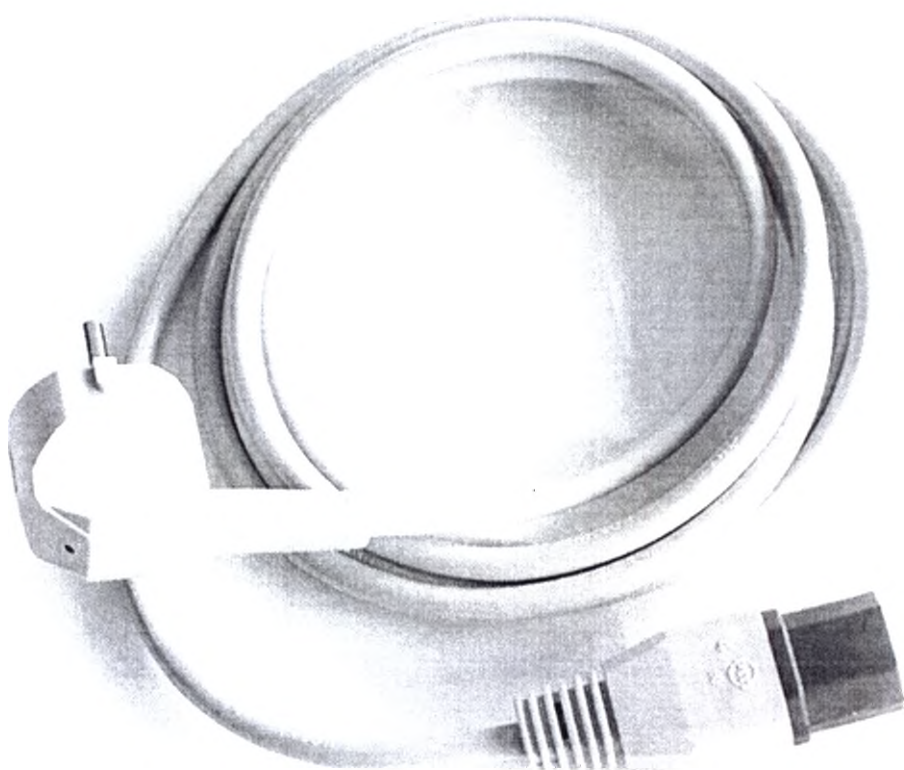

30. Сетевой кабель, 2P+PE, 2 м, тип СЕЕ



31. Сетевой кабель, 2P+PE, 5 м, тип CEE



32. Оптоволоконный кабель

Все перечисленные выше фотографические изображения просим распространить на все варианты исполнения медицинского изделия, так как внешний вид вариантов исполнений и их комплектующих идентичен, а именно:

I. Система мониторинга пациента во время магнитно-резонансной томографии MAGLIFE RT-1, в варианте исполнения MAGLIFE RT-1/ESN, в составе:

1. Монитор пациента в условиях MPT MAGLIFE RT-1;
2. Ретранслирующий экран (монитор) MAGSCREEN RT-1 (при необходимости);
3. Соединительное устройство MAGLINK для системы MAGLIFE / MAGSCREEN (при необходимости);
4. Электроды ЭКГ для взрослых/детей с весом > 3 кг, одноразовые – 4 шт. в упаковке, не более 20 уп. (при необходимости);
5. Электроды ЭКГ для новорожденных с весом < 5 кг, одноразовые - 4 шт. в упаковке, не более 20 уп. (при необходимости);
6. Беспроводной датчик ЭКГ;
7. Манжета для новорожденных мягкая, 2,5 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);
8. Манжета для новорожденных мягкая, 4 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);
9. Манжета для новорожденных мягкая, 6 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);
10. Манжета для детей, 8 см – не более 10 шт. (при необходимости);
11. Манжета для детей, 10 см – не более 10 шт. (при необходимости);
12. Манжета для взрослых, 14 см – не более 10 шт. (при необходимости);
13. Манжета для взрослых, 17 см – не более 10 шт. (при необходимости);
14. Манжета для взрослых, 20 см – не более 10 шт. (при необходимости);
15. Трубка манжеты 5 м;
16. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для взрослых тип W-SA (при необходимости);
17. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для детей тип W-SP (при необходимости);
18. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для детей тип W-SVS, (для очень маленьких детей);
19. Мягкие ремешки для очень маленьких датчиков SpO₂, одноразовые - 10 шт. (при необходимости);
20. Сетевой кабель, 2P+PE, 2 м, тип CEE (при необходимости);
21. Сетевой кабель, 2P+PE, 5 м, тип CEE (при необходимости);
22. Оптоволоконный кабель.

II. Система мониторинга пациента во время магнитно-резонансной томографии MAGLIFE RT-1, в варианте исполнения MAGLIFE RT-1/ESNPC, в составе:

1. Монитор пациента в условиях MPT MAGLIFE RT-1;

2. Ретранслирующий экран (монитор) MAGSCREEN RT-1 (при необходимости);
3. Соединительное устройство MAGLINK для системы MAGLIFE / MAGSCREEN (при необходимости);
4. Электроды ЭКГ для взрослых/детей с весом > 3 кг, одноразовые - 4 шт. в упаковке, не более 20 уп. (при необходимости);
5. Электроды ЭКГ для новорожденных с весом < 5 кг, одноразовые - 4 шт. в упаковке, не более 20 уп. (при необходимости);
6. Беспроводной датчик ЭКГ;
7. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для взрослых тип W-SA (при необходимости);
8. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для детей тип W-SP (при необходимости);
9. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для детей тип W-SVS (для очень маленьких детей) (при необходимости);
10. Мягкие ремешки для очень маленьких датчиков SpO2 - 10 шт. (при необходимости);
11. Манжета для новорожденных мягкая, 2,5 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);
12. Манжета для новорожденных мягкая, 4 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);
13. Манжета для новорожденных мягкая, 6 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);
14. Манжета для детей, 8 см – не более 10 шт. (при необходимости);
15. Манжета для детей, 10 см – не более 10 шт. (при необходимости);
16. Манжета для взрослых, 14 см – не более 10 шт. (при необходимости);
17. Манжета для взрослых, 17 см – не более 10 шт. (при необходимости);
18. Манжета для взрослых, 20 см – не более 10 шт. (при необходимости);
19. Трубка манжеты 5 м;
20. Комплект, состоящий из многократного датчика "SENSOR", кабеля адаптера и 5 одноразовых трубок давления;
21. Т-образный адаптер дыхательных путей, одноразовый - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);
22. Адаптер дыхательных путей 90°, одноразовый - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);
23. Пробоотборная трубка CO2 для взрослых/детей 3,0 м, одноразовая - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);
24. Пробоотборная трубка CO2 для новорожденных 3,0 м, одноразовая - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);
25. Водяная ловушка для взрослых/детей (при необходимости);
26. Водяная ловушка для новорожденных (при необходимости);
27. Сетевой кабель, 2P+PE, 2 м, тип СЕЕ (при необходимости);
28. Сетевой кабель, 2P+PE, 5 м, тип СЕЕ (при необходимости);

29. Оптоволоконный кабель.

III. Система мониторинга пациента во время магнитно-резонансной томографии MAGLIFE RT-1, в варианте исполнения MAGLIFE RT-1 / SNC, в составе:

1. Монитор пациента в условиях MPT MAGLIFE RT-1;
2. Ретранслирующий экран (монитор) MAGSCREEN RT-1 (при необходимости);
3. Соединительное устройство MAGLINK для системы MAGLIFE / MAGSCREEN (при необходимости);
4. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для взрослых тип W-SA (при необходимости);
5. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для детей тип W-SP (при необходимости);
6. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для детей тип W-SVS (для очень маленьких детей) (при необходимости);
7. Мягкие ремешки для очень маленьких датчиков SpO₂ - 10 шт., одноразовые (при необходимости);
8. Манжета для новорожденных мягкая, 2,5 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);
9. Манжета для новорожденных мягкая, 4 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);
10. Манжета для новорожденных мягкая, 6 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);
11. Манжета для детей, 8 см – не более 10 шт. (при необходимости);
12. Манжета для детей, 10 см – не более 10 шт. (при необходимости);
13. Манжета для взрослых, 14 см – не более 10 шт. (при необходимости);
14. Манжета для взрослых, 17 см – не более 10 шт. (при необходимости);
15. Манжета для взрослых, 20 см – не более 10 шт. (при необходимости);
16. Трубка манжеты 5 м;
17. Т-образный адаптер дыхательных путей, одноразовый - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);
18. Адаптер дыхательных путей 90°, одноразовый - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);
19. Пробоотборная трубка CO₂ для взрослых/детей 3,0 м, одноразовая - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);
20. Пробоотборная трубка CO₂ для новорожденных 3,0 м, одноразовая - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);
21. Водяная ловушка для взрослых/детей (при необходимости);
22. Водяная ловушка для новорожденных (при необходимости);
23. Сетевой кабель, 2P+PE, 2 м, тип СЕЕ (при необходимости);
24. Сетевой кабель, 2P+PE, 5 м, тип СЕЕ (при необходимости);
25. Оптоволоконный кабель.

IV. Система мониторинга пациента во время магнитно-резонансной томографии MAGLIFE RT-1, в варианте исполнения MAGLIFE RT-1 / ESNPCAO в составе:

1. Монитор пациента в условиях MPT MAGLIFE RT-1;
2. Ретранслирующий экран (монитор) MAGSCREEN RT-1 (при необходимости);
3. Соединительное устройство MAGLINK для системы MAGLIFE / MAGSCREEN (при необходимости);
4. Электроды ЭКГ для взрослых/детей с весом > 3 кг, одноразовые - 4 шт. в упаковке, не более 20 уп. (при необходимости);
5. Электроды ЭКГ для новорожденных с весом < 5 кг, одноразовые - 4 шт. в упаковке, не более 20 уп. (при необходимости);
6. Беспроводной датчик ЭКГ;
7. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для взрослых тип W-SA (при необходимости);
8. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для детей тип W-SP (при необходимости);
9. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для детей тип W-SVS (для очень маленьких детей) (при необходимости);
10. Мягкие ремешки для очень маленьких датчиков SpO₂, одноразовые - 10 шт. (при необходимости);
11. Манжета для новорожденных мягкая, 2,5 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);
12. Манжета для новорожденных мягкая, 4 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);
13. Манжета для новорожденных мягкая, 6 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);
14. Манжета для детей, 8 см – не более 10 шт. (при необходимости);
15. Манжета для детей, 10 см – не более 10 шт. (при необходимости);
16. Манжета для взрослых, 14 см – не более 10 шт. (при необходимости);
17. Манжета для взрослых, 17 см – не более 10 шт. (при необходимости);
18. Манжета для взрослых, 20 см – не более 10 шт. (при необходимости);
19. Трубка манжеты, 5 м;
20. Комплект, состоящий из многоразового датчика "SENSOROR", кабеля адаптера и 5 одноразовых трубок давления;
21. Т-образный адаптер дыхательных путей, одноразовый - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);
22. Адаптер дыхательных путей 90°, одноразовый - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);
23. Пробоотборная трубка CO₂ для взрослых/детей 3,0 м, одноразовая - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);
24. Пробоотборная трубка CO₂ для новорожденных 3,0 м, одноразовая - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);

25. Водяная ловушка для взрослых/детей (при необходимости);
26. Водяная ловушка для новорожденных (при необходимости);
27. Сетевой кабель, 2P+PE, 2 м, тип СЕЕ (при необходимости);
28. Сетевой кабель, 2P+PE, 5 м, тип СЕЕ (при необходимости);
29. Оптоволоконный кабель.

V. Система мониторинга пациента во время магнитно-резонансной томографии MAGLIFE RT-1, в варианте исполнения MAGLIFE RT-1 / ESNPCAOT в составе:

1. Монитор пациента в условиях МРТ MAGLIFE RT-1;
2. Ретранслирующий экран (монитор) MAGSCREEN RT-1 (при необходимости);
3. Соединительное устройство MAGLINK для системы MAGLIFE / MAGSCREEN (при необходимости);
4. Электроды ЭКГ для взрослых/детей с весом > 3 кг - 4 шт. в упаковке, не более 20 уп. (при необходимости);
5. Электроды ЭКГ для новорожденных с весом < 5 кг - 4 шт. в упаковке, не более 20 уп. (при необходимости);
6. Беспроводной датчик ЭКГ;
7. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для взрослых тип W-SA (при необходимости);
8. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для детей тип W-SP (при необходимости);
9. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для детей тип W-SVS (для очень маленьких детей) (при необходимости);
10. Мягкие ремешки для очень маленьких датчиков SpO₂, одноразовые - 10 шт. (при необходимости);
11. Манжета для новорожденных мягкая, 2.5 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);
12. Манжета для новорожденных мягкая, 4 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);
13. Манжета для новорожденных мягкая, 6 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);
14. Манжета для детей, 8 см – не более 10 шт. (при необходимости);
15. Манжета для детей, 10 см – не более 10 шт. (при необходимости);
16. Манжета для взрослых, 14 см – не более 10 шт. (при необходимости);
17. Манжета для взрослых, 17 см – не более 10 шт. (при необходимости);
18. Манжета для взрослых, 20 см – не более 10 шт. (при необходимости);
19. Трубка манжеты, 5 м;
20. Комплект, состоящий из многоразового датчика "SENSOROR", кабеля адаптера и 5 одноразовых трубок давления;
21. Т-образный адаптер дыхательных путей, одноразовый - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);

22. Адаптер дыхательных путей 90°, одноразовый - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);
23. Пробоотборная трубка CO₂ для взрослых/детей 3,0 м, одноразовая - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);
24. Пробоотборная трубка CO₂ для новорожденных 3,0 м, одноразовая - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);
25. Водяная ловушка для взрослых/детей (при необходимости);
26. Водяная ловушка для новорожденных (при необходимости);
27. Температурный датчик, использующий оптический принцип измерения, для наружного/кожного применения;
28. Сетевой кабель, 2P+PE, 2 м, тип CEE (при необходимости);
29. Сетевой кабель, 2P+PE, 5 м, тип CEE (при необходимости);
30. Оптоволоконный кабель.

VI. Система мониторинга пациента во время магнитно-резонансной томографии MAGLIFE RT-1, в варианте исполнения MAGLIFE RT-1 / ESNPCAOR, в составе:

1. Монитор пациента в условиях MPT MAGLIFE RT-1;
2. Ретранслирующий экран (монитор) MAGSCREEN RT-1 (при необходимости);
3. Соединительное устройство MAGLINK для системы MAGLIFE / MAGSCREEN (при необходимости);
4. Электроды ЭКГ для взрослых/детей с весом > 3 кг - 4 шт. в упаковке, не более 20 уп. (при необходимости);
5. Электроды ЭКГ для новорожденных с весом < 5 кг - 4 шт. в упаковке, не более 20 уп. (при необходимости);
6. Беспроводной датчик ЭКГ;
7. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для взрослых тип W-SA (при необходимости);
8. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для детей тип W-SP (при необходимости);
9. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для детей тип W-SVS (для очень маленьких детей) (при необходимости);
10. Мягкие ремешки для очень маленьких датчиков SpO₂, одноразовые - 10 шт. (при необходимости);
11. Манжета для новорожденных мягкая, 2,5 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);
12. Манжета для новорожденных мягкая, 4 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);
13. Манжета для новорожденных мягкая, 6 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);
14. Манжета для детей, 8 см – не более 10 шт. (при необходимости);
15. Манжета для детей, 10 см – не более 10 шт. (при необходимости);
16. Манжета для взрослых, 14 см – не более 10 шт. (при необходимости);

17. Манжета для взрослых, 17 см – не более 10 шт. (при необходимости);
18. Манжета для взрослых, 20 см – не более 10 шт. (при необходимости);
19. Трубка манжеты, 5 м;
20. Комплект, состоящий из многоразового датчика "SENSOROR", кабель адаптера и 5 одноразовых трубок давления;
21. Т-образный адаптер дыхательных путей одноразовый - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);
22. Адаптер дыхательных путей 90° одноразовый - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);
23. Пробоотборная трубка CO₂ для взрослых/детей 3,0 м - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);
24. Пробоотборная трубка CO₂ для новорожденных 3,0 м - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);
25. Водяная ловушка для взрослых/детей (при необходимости);
26. Водяная ловушка для новорожденных (при необходимости);
27. Датчик потока SPIRIT, для взрослых/детей, 2.5 м, с пробоотборной трубкой, одноразовый (при необходимости);
28. Датчик потока SPIRIT, для детей/новорожденных, 2.5 м, с пробоотборной трубкой, одноразовый (при необходимости);
29. Сетевой кабель, 2P+PE, 2 м, тип CEE (при необходимости);
30. Сетевой кабель, 2P+PE, 5 м, тип CEE (при необходимости);
31. Оптоволоконный кабель.

VII. Система мониторинга пациента во время магнитно-резонансной томографии MAGLIFE RT-1, в варианте исполнения MAGLIFE RT-1 / ESNPCAORT, в составе:

1. Монитор пациента в условиях MPT MAGLIFE RT-1;
2. Ретранслирующий экран (монитор) MAGSCREEN RT-1 (при необходимости);
3. Соединительное устройство MAGLINK для системы MAGLIFE / MAGSCREEN (при необходимости);
4. Электроды ЭКГ для взрослых/детей с весом > 3 кг, одноразовые - 4 шт. в упаковке, не более 20 уп. (при необходимости);
5. Электроды ЭКГ для новорожденных с весом < 5 кг, одноразовые - 4 шт. в упаковке, не более 20 уп. (при необходимости);
6. Беспроводной датчик ЭКГ;
7. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для взрослых тип W-SA (при необходимости);
8. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для детей тип W-SP (при необходимости);
9. Беспроводной датчик пульсоксиметрии для детей тип W-SVS (для очень маленьких детей) (при необходимости);
10. Мягкие ремешки для очень маленьких датчиков SpO₂, одноразовые - 10 шт. (при необходимости);

11. Манжета для новорожденных мягкая, 2,5 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);

12. Манжета для новорожденных мягкая, 4 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);

13. Манжета для новорожденных мягкая, 6 см, одноразовая – не более 10 шт. (при необходимости);

14. Манжета для детей, 8 см – не более 10 шт. (при необходимости);

15. Манжета для детей, 10 см – не более 10 шт. (при необходимости);

16. Манжета для взрослых, 14 см – не более 10 шт. (при необходимости);

17. Манжета для взрослых, 17 см – не более 10 шт. (при необходимости);

18. Манжета для взрослых, 20 см – не более 10 шт. (при необходимости);

19. Трубка манжеты, 5 м;

20. Комплект, состоящий из многоразового датчика "SENSOROR", кабеля адаптера и 5 одноразовых трубок давления;

21. Т-образный адаптер дыхательных путей, одноразовый - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости).

22. Адаптер дыхательных путей 90°, одноразовый - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);

23. Пробоотборная трубка CO₂ для взрослых/детей 3,0 м, одноразовая - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);

24. Пробоотборная трубка CO₂ для новорожденных 3,0 м, одноразовая - 10 шт. в упаковке, не более 10 упаковок (при необходимости);

25. Водяная ловушка для взрослых/детей (при необходимости);

26. Водяная ловушка для новорожденных (при необходимости);

27. Датчик потока SPIRIT, для взрослых/детей, 2,5 м, с пробоотборной трубкой, одноразовый (при необходимости);

28. Датчик потока SPIRIT, для детей/новорожденных, 2,5 м, с пробоотборной трубкой, одноразовый (при необходимости);

29. Температурный датчик, использующий оптический принцип измерения, для наружного/кожного применения;

30. Сетевой кабель, 2P+PE, 2 м, тип СЕЕ (при необходимости);

31. Сетевой кабель, 2P+PE, 5 м, тип СЕЕ (при необходимости);

32. Оптоволоконный кабель.

Всего прошито и скреплено
печатью 48 листа (ов)

Казанчян К.П.

