

УТВЕРЖДАЮ


Директор
ООО «Онкодиагностика АТЛАС»

В. А. Милейко
2021 г.


The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text 'Общество с ограниченной ответственностью' is written along the top arc, and 'Москва' is at the bottom. In the center, there is a logo consisting of a stylized 'A' made of four squares, with the text 'Онкодиагностика Атлас' below it. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Фотографические изображения медицинского изделия


«Набор реагентов для выявления мутаций, ассоциированных с раком молочной железы и раком яичников, методом высокопроизводительного секвенирования (Соло-тест ABC) по ТУ 21.20.23-001-91709359-2018»

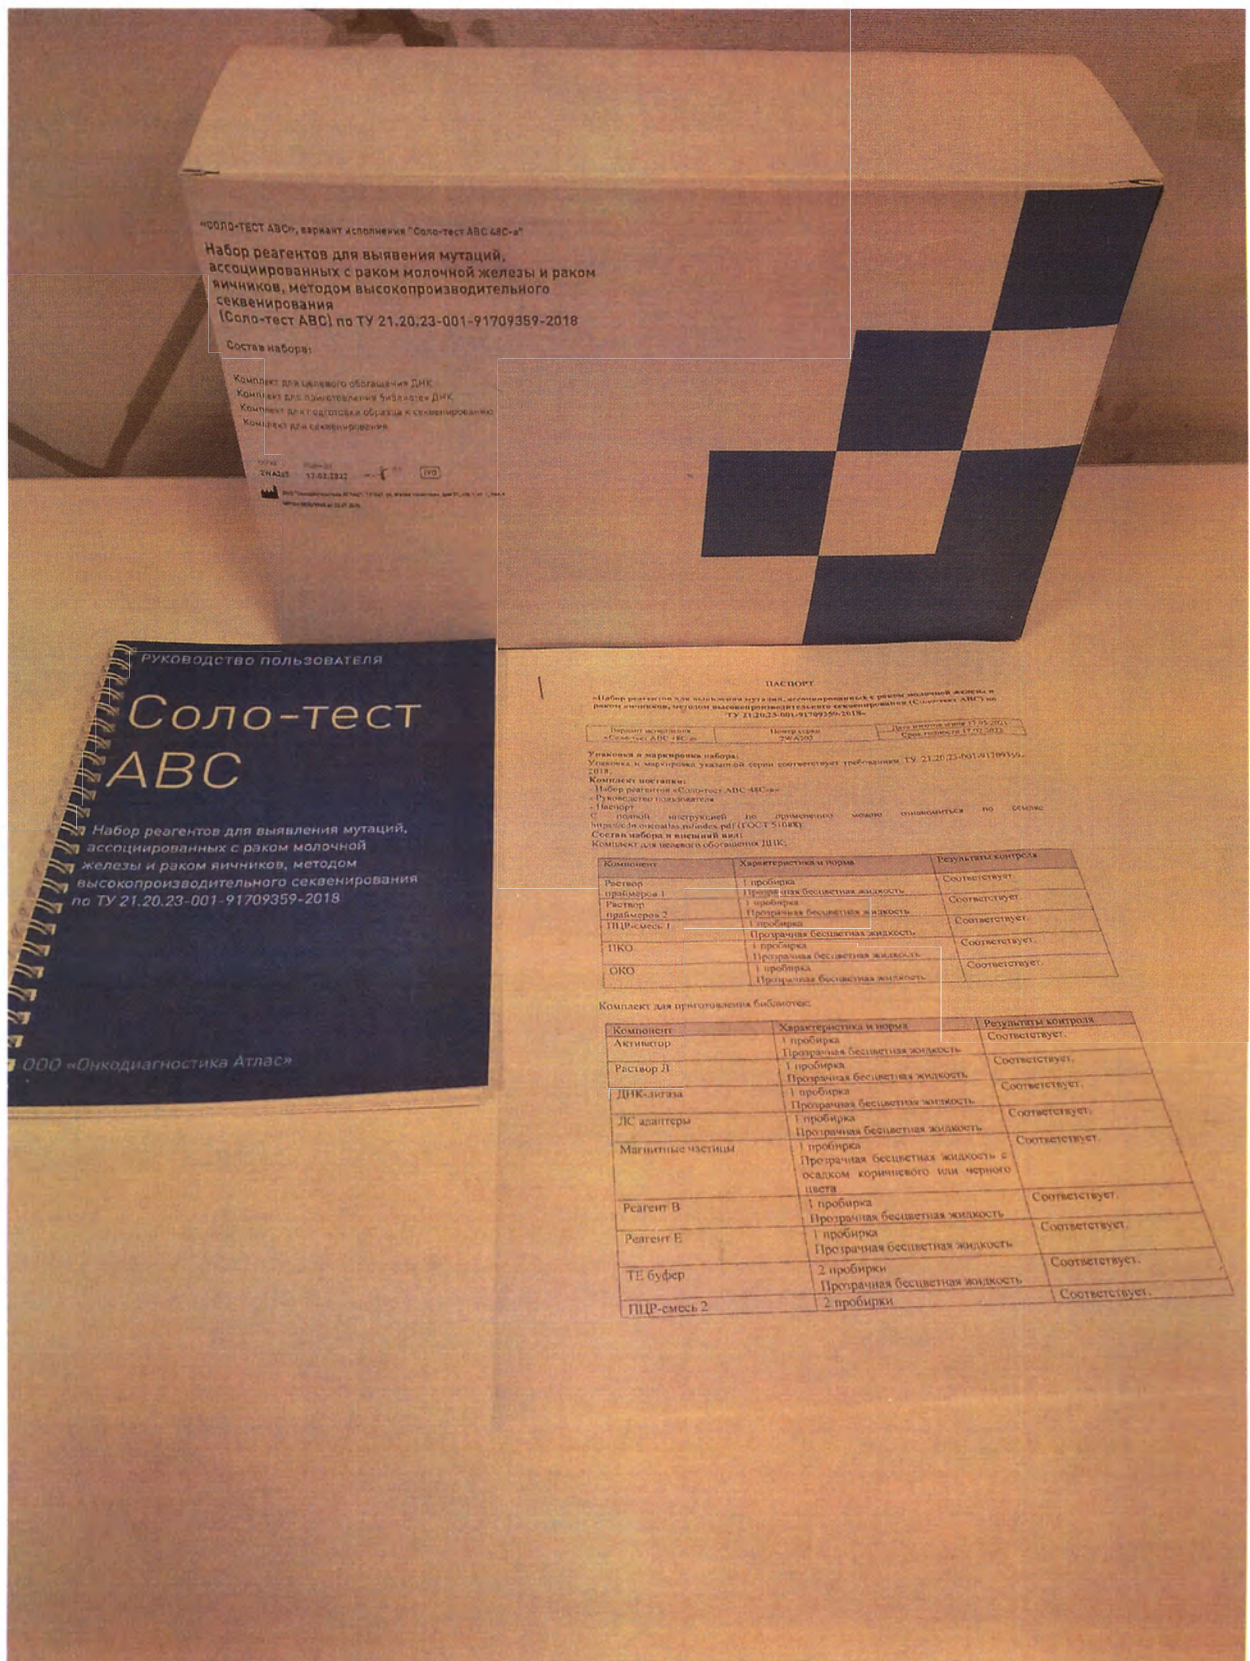


Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест АВС 48С-а», комплект поставки

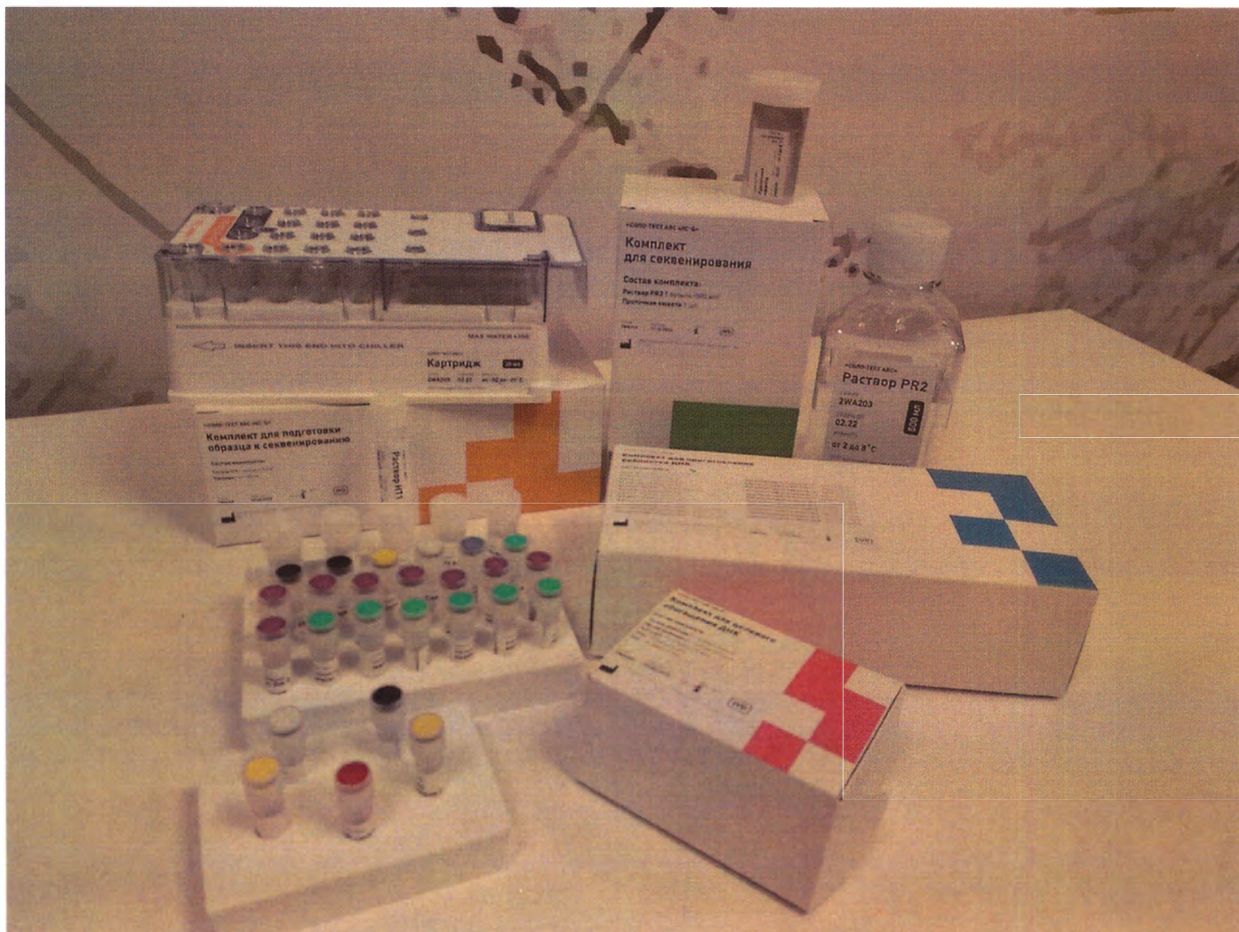


Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест ABC 48С-а», общий вид

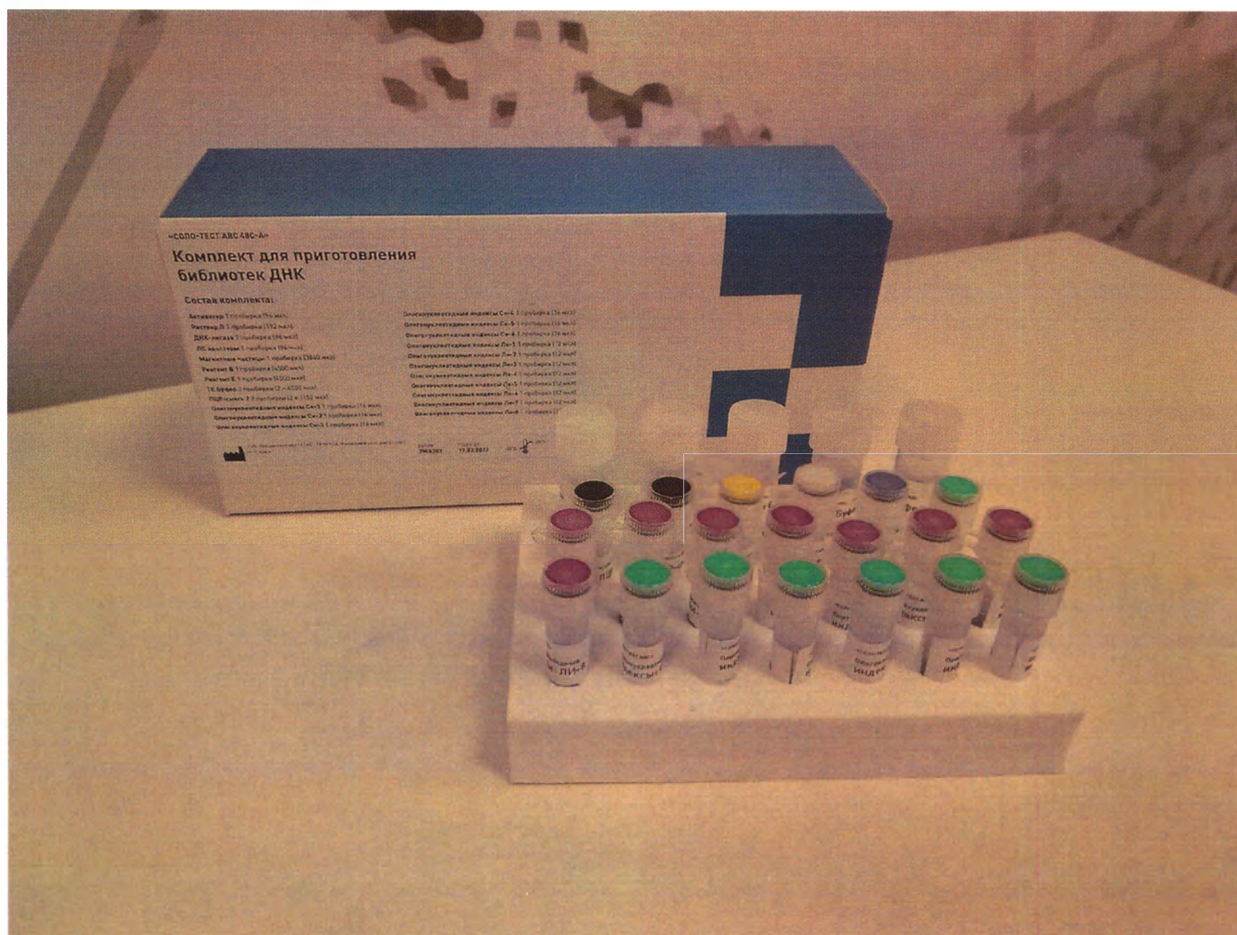


Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест ABC 48С-а», комплект для приготовления библиотек ДНК

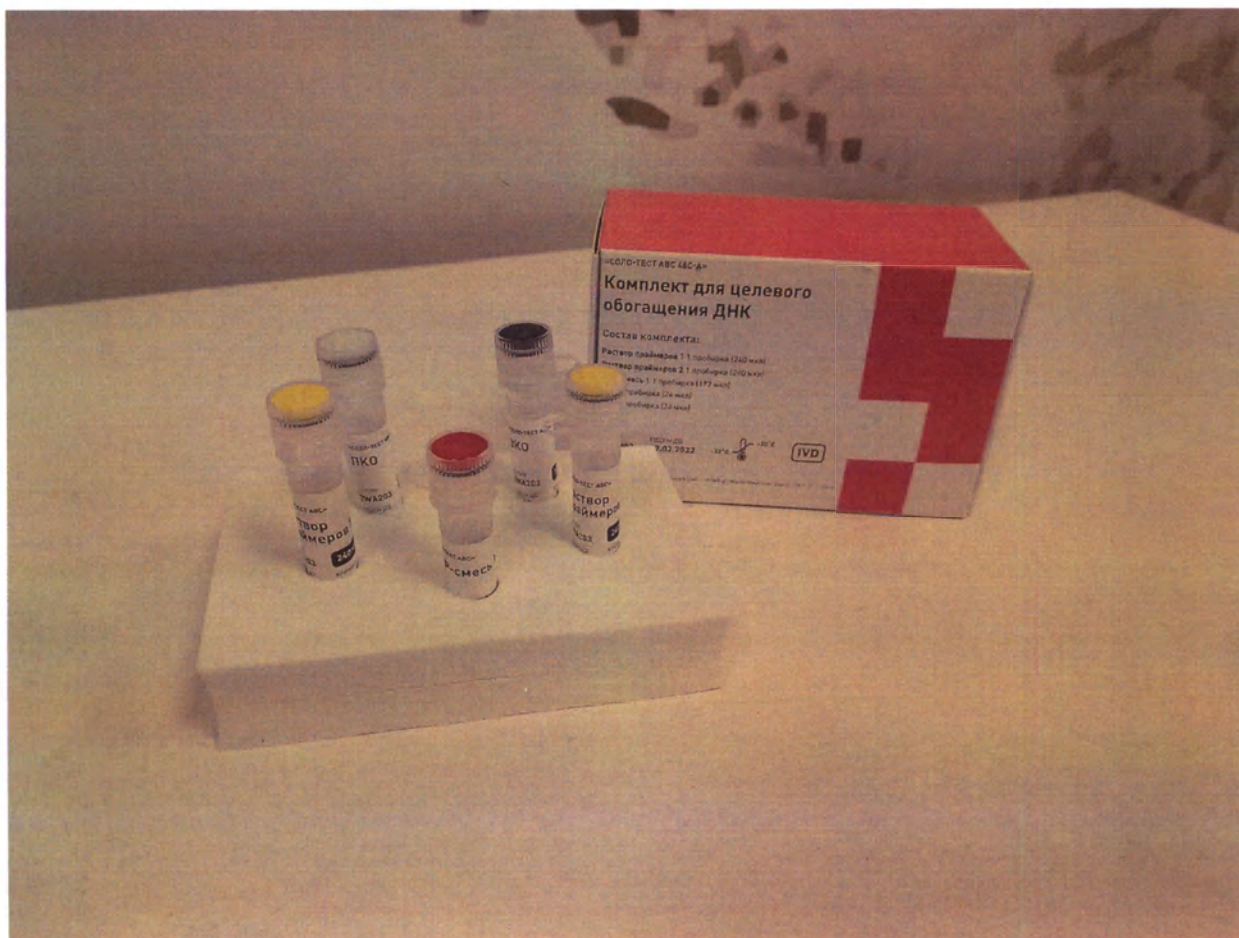

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест ABC 48C-а», комплект для целевого обогащения

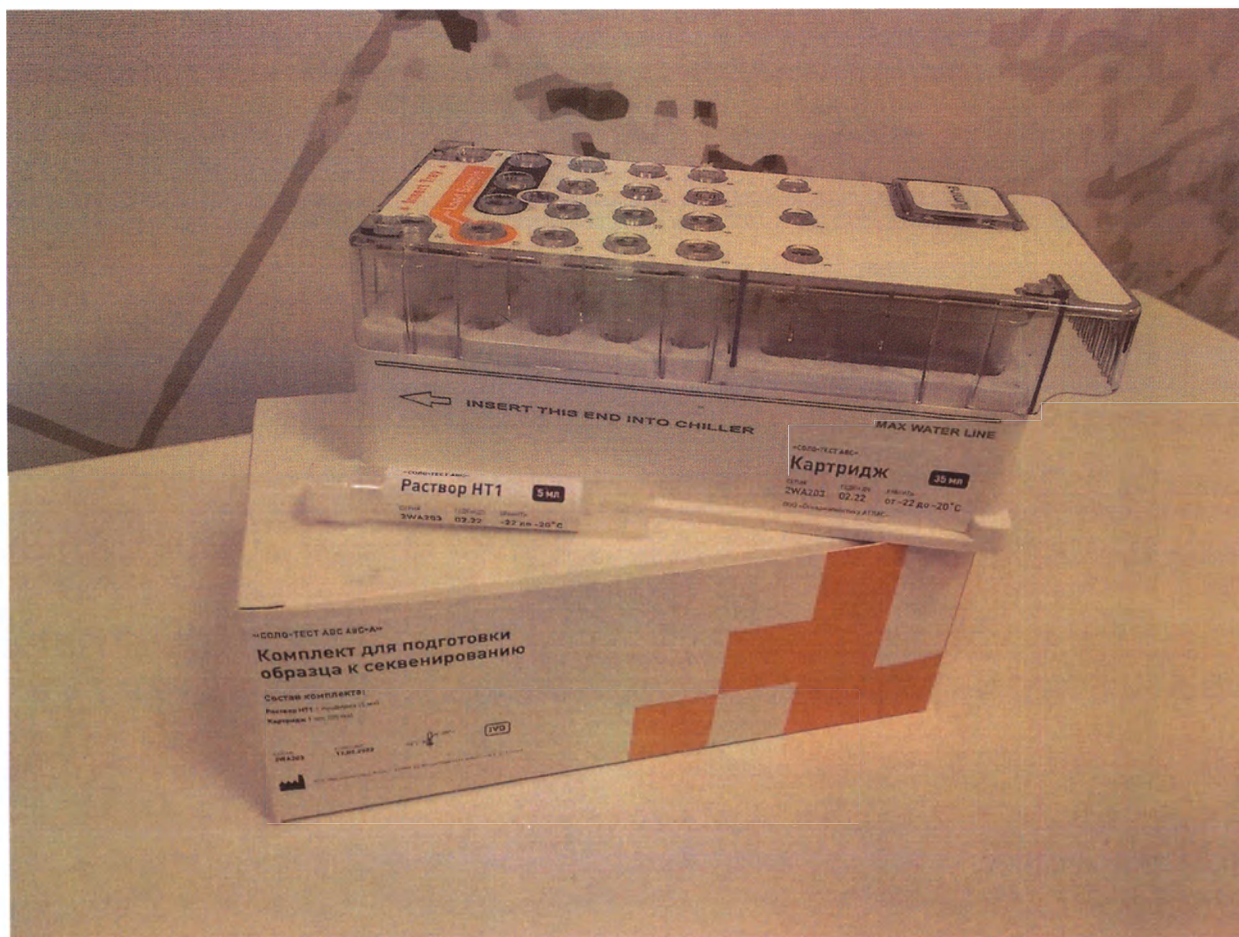


Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест ABC 48C-a», комплект для подготовки образца к секвенированию

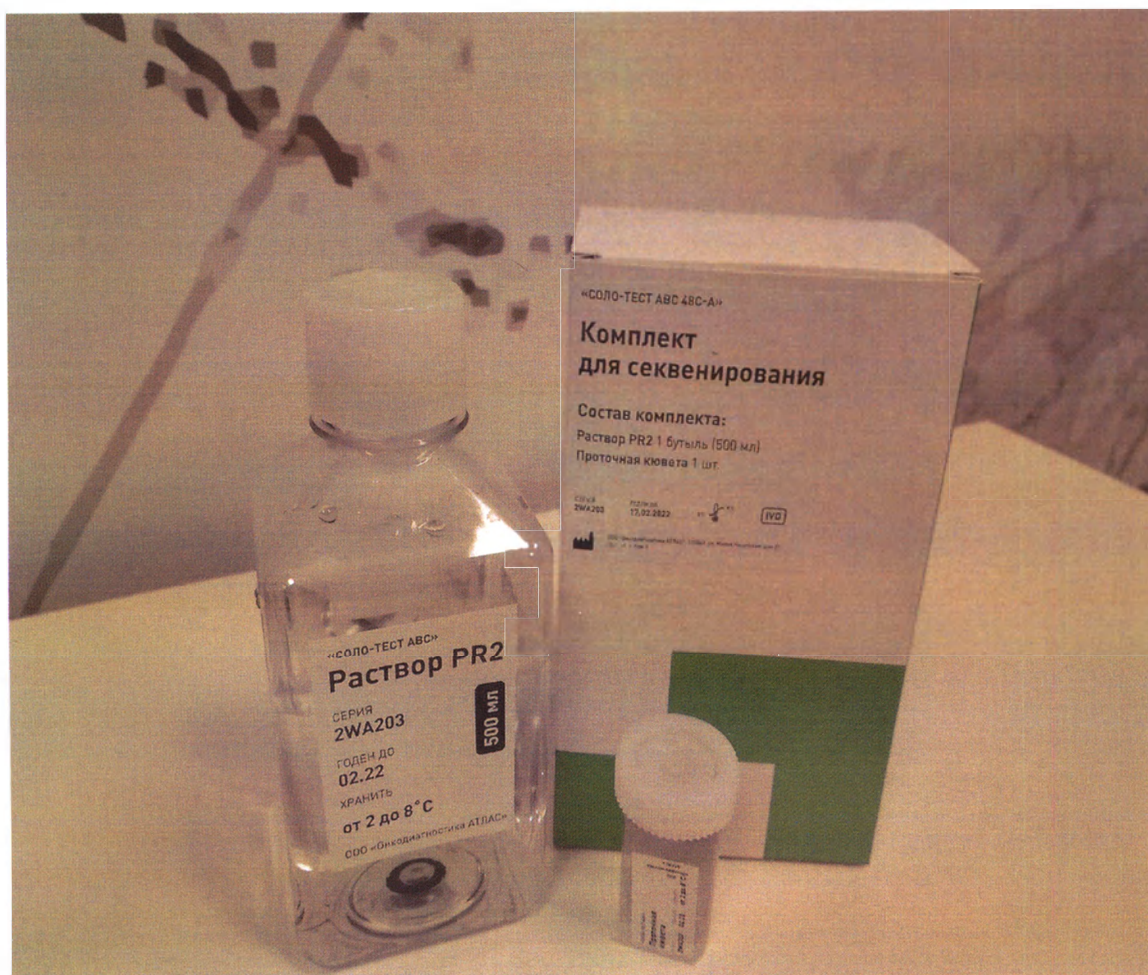

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест ABC 48С-а», комплект для секвенирования




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест ABC 48С-б», общий вид

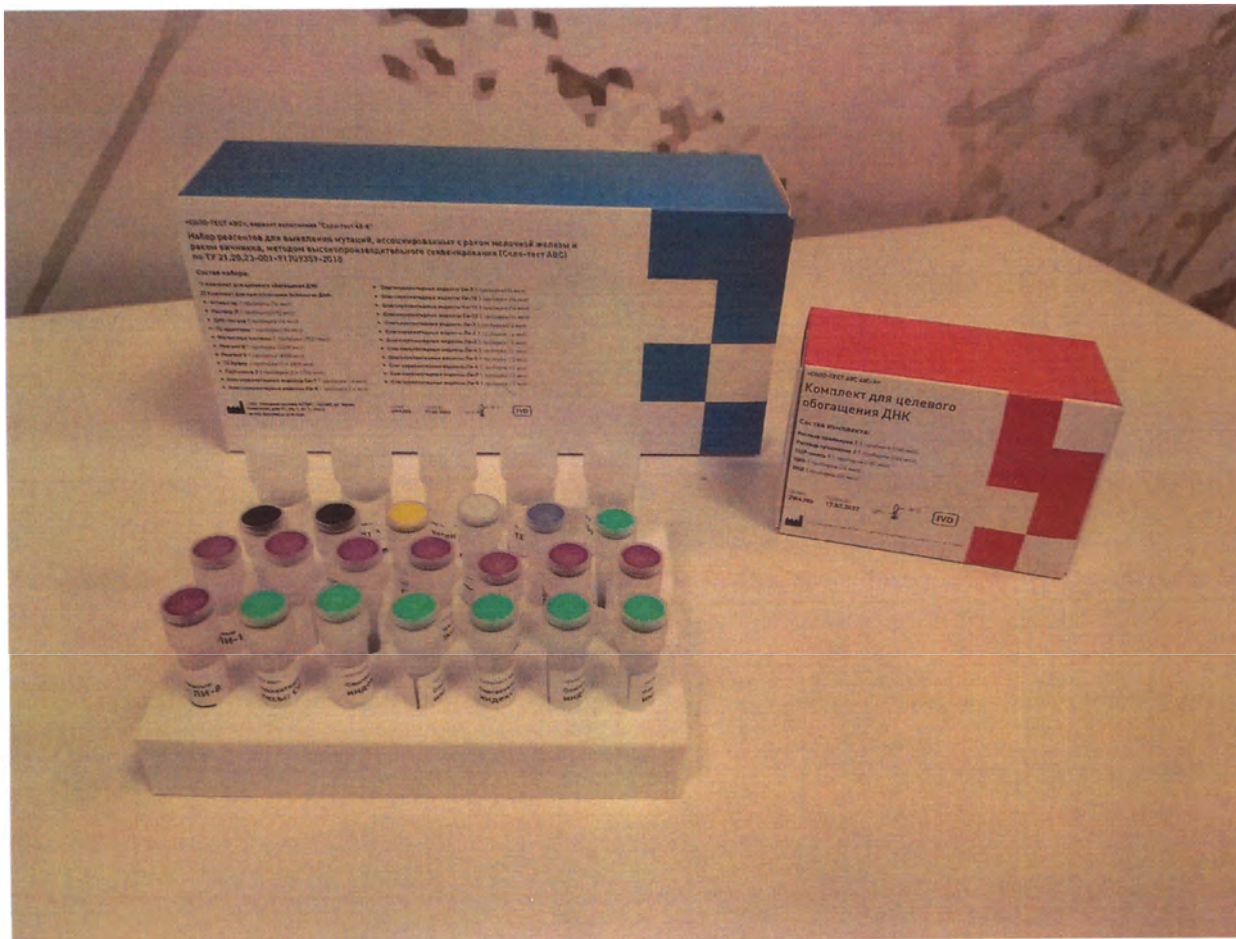


Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест ABC 48-а», общий вид




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест ABC 48С-б», комплект для приготовления библиотек ДНК

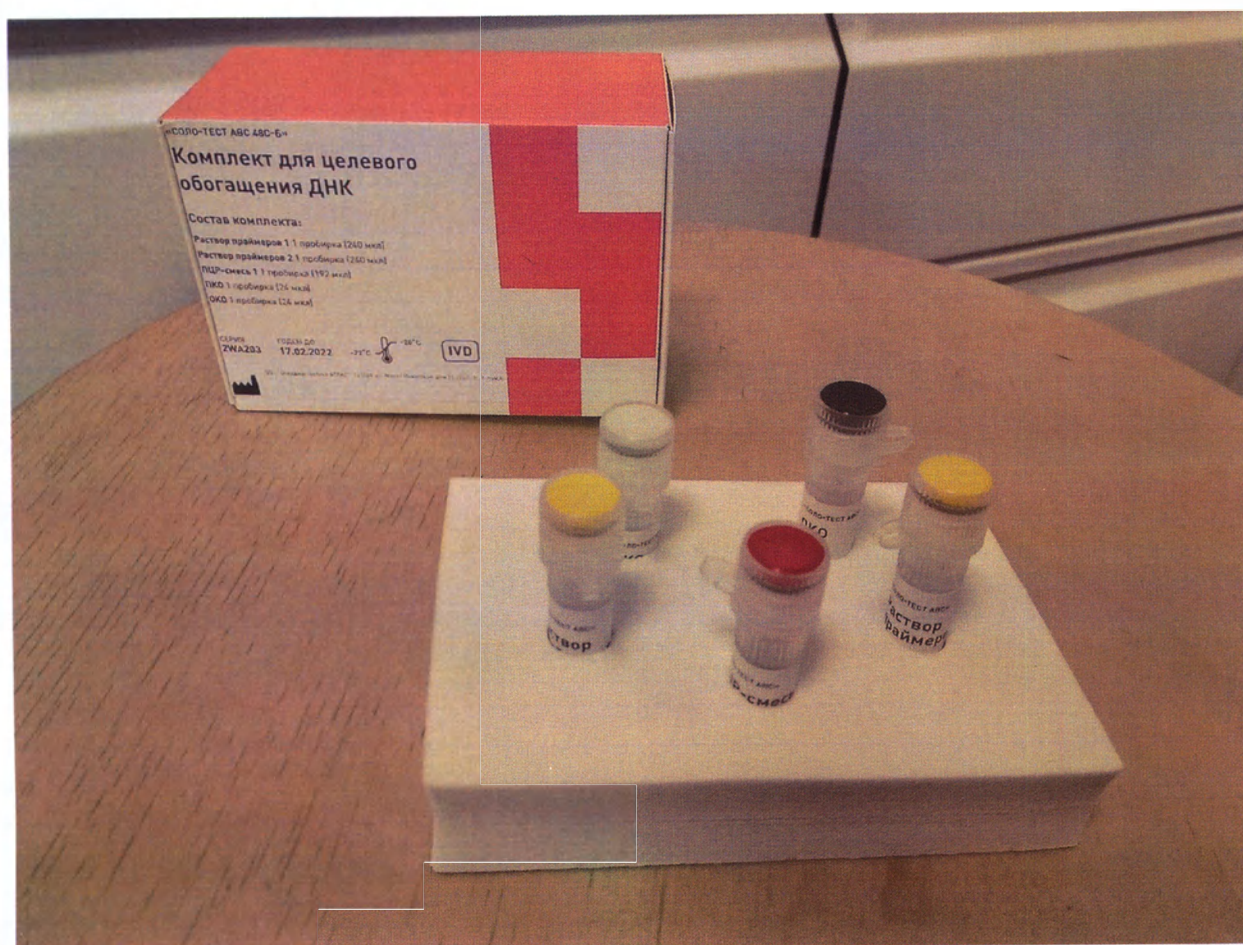


Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест ABC 48С-б», комплект для приготовления библиотек ДНК

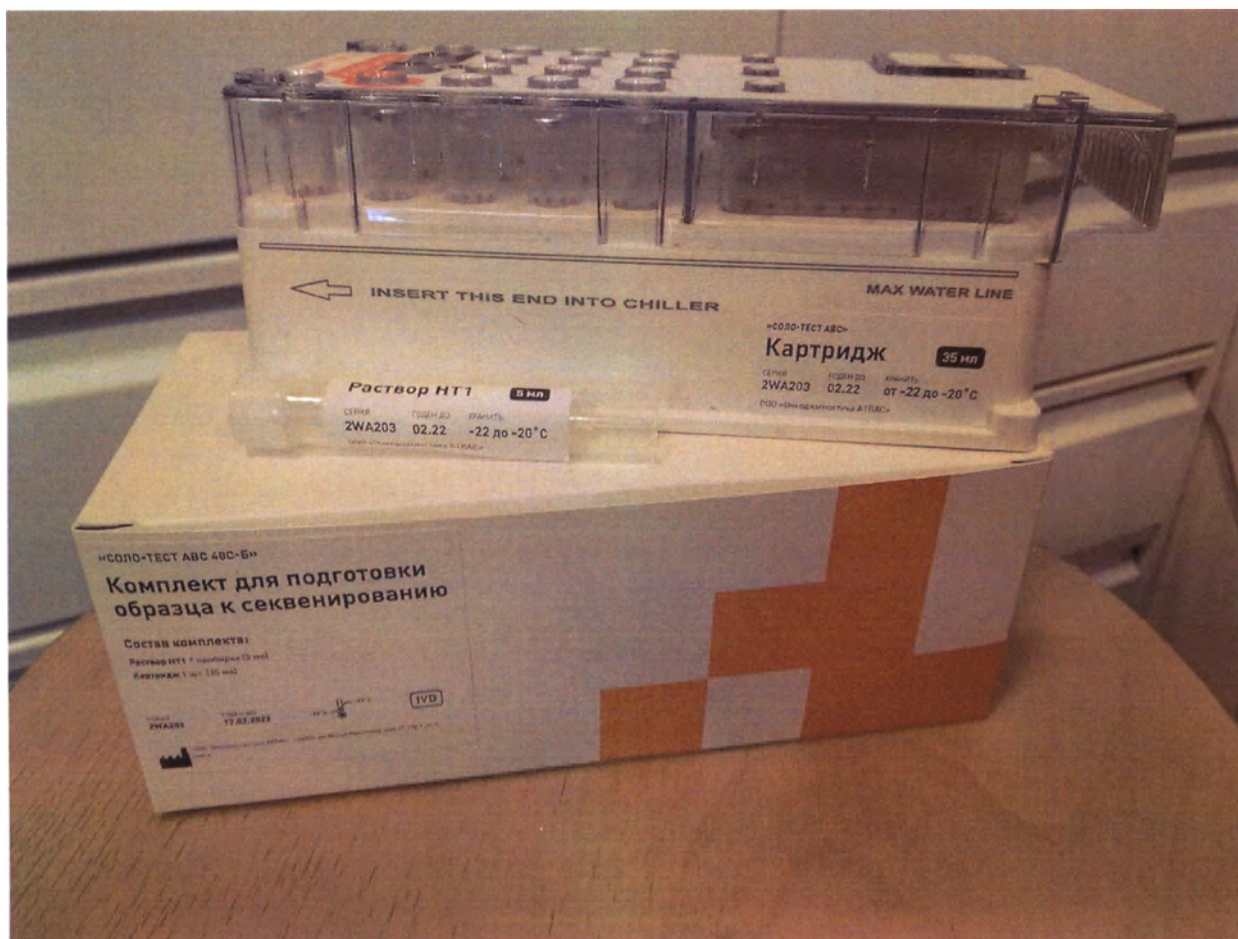

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест ABC 48C-б»: комплект для подготовки образца к секвенированию

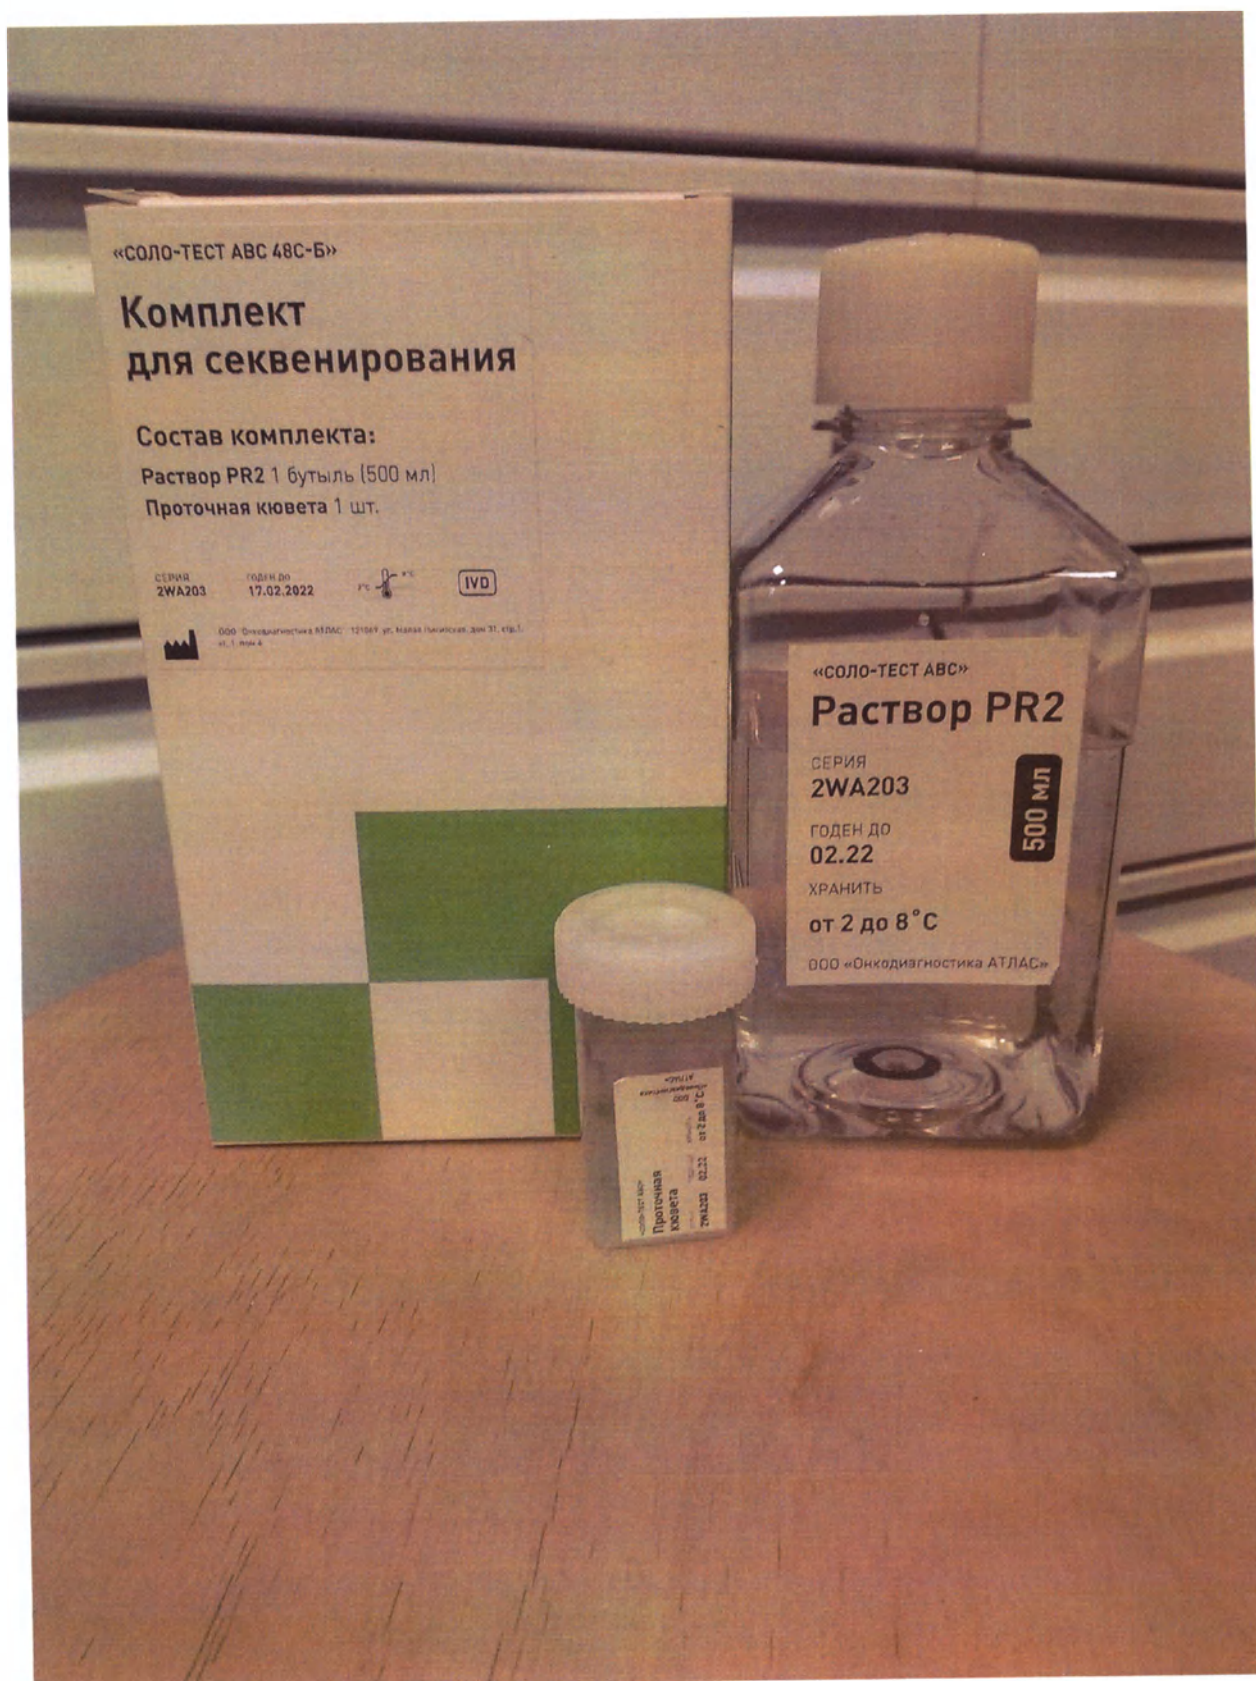


Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест АВС 48С-б»: комплект для секвенирования

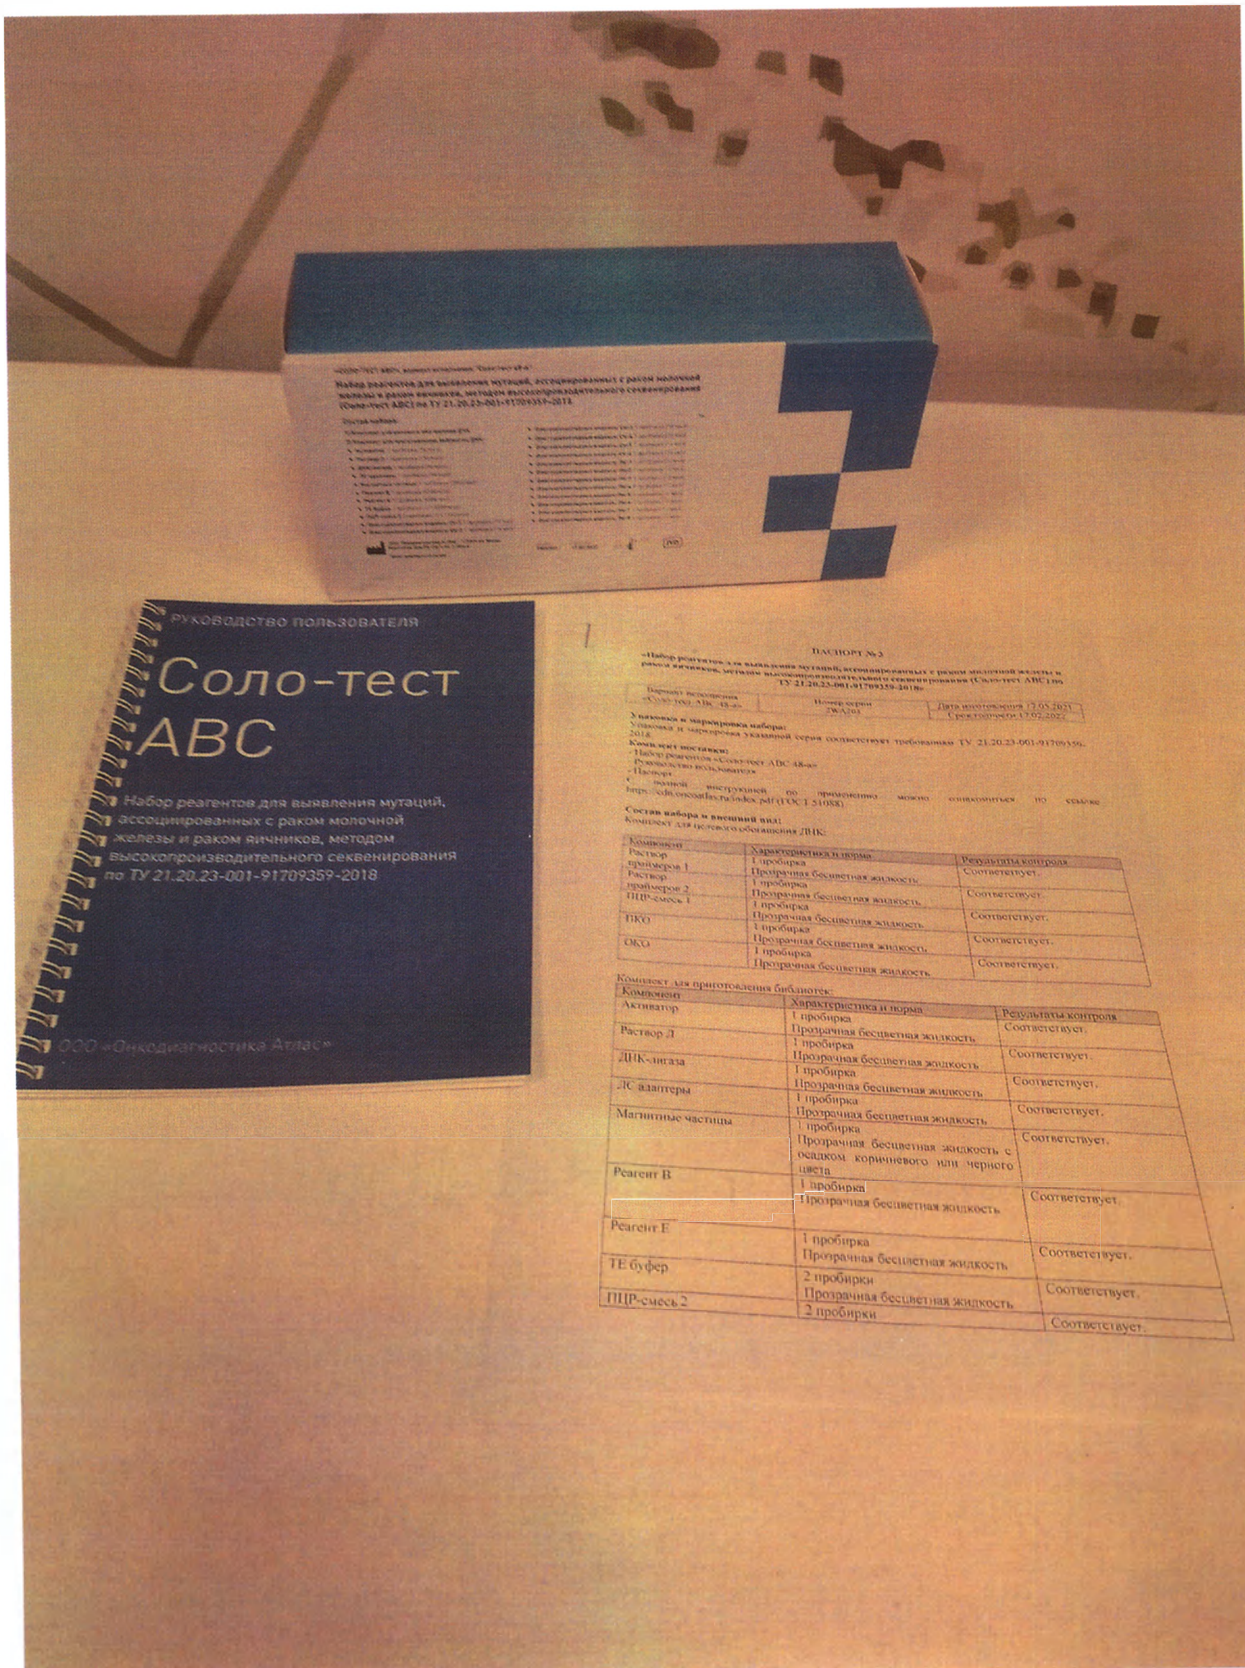

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест ABC 48-б», комплект поставки




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест АВС 48-б», общий вид

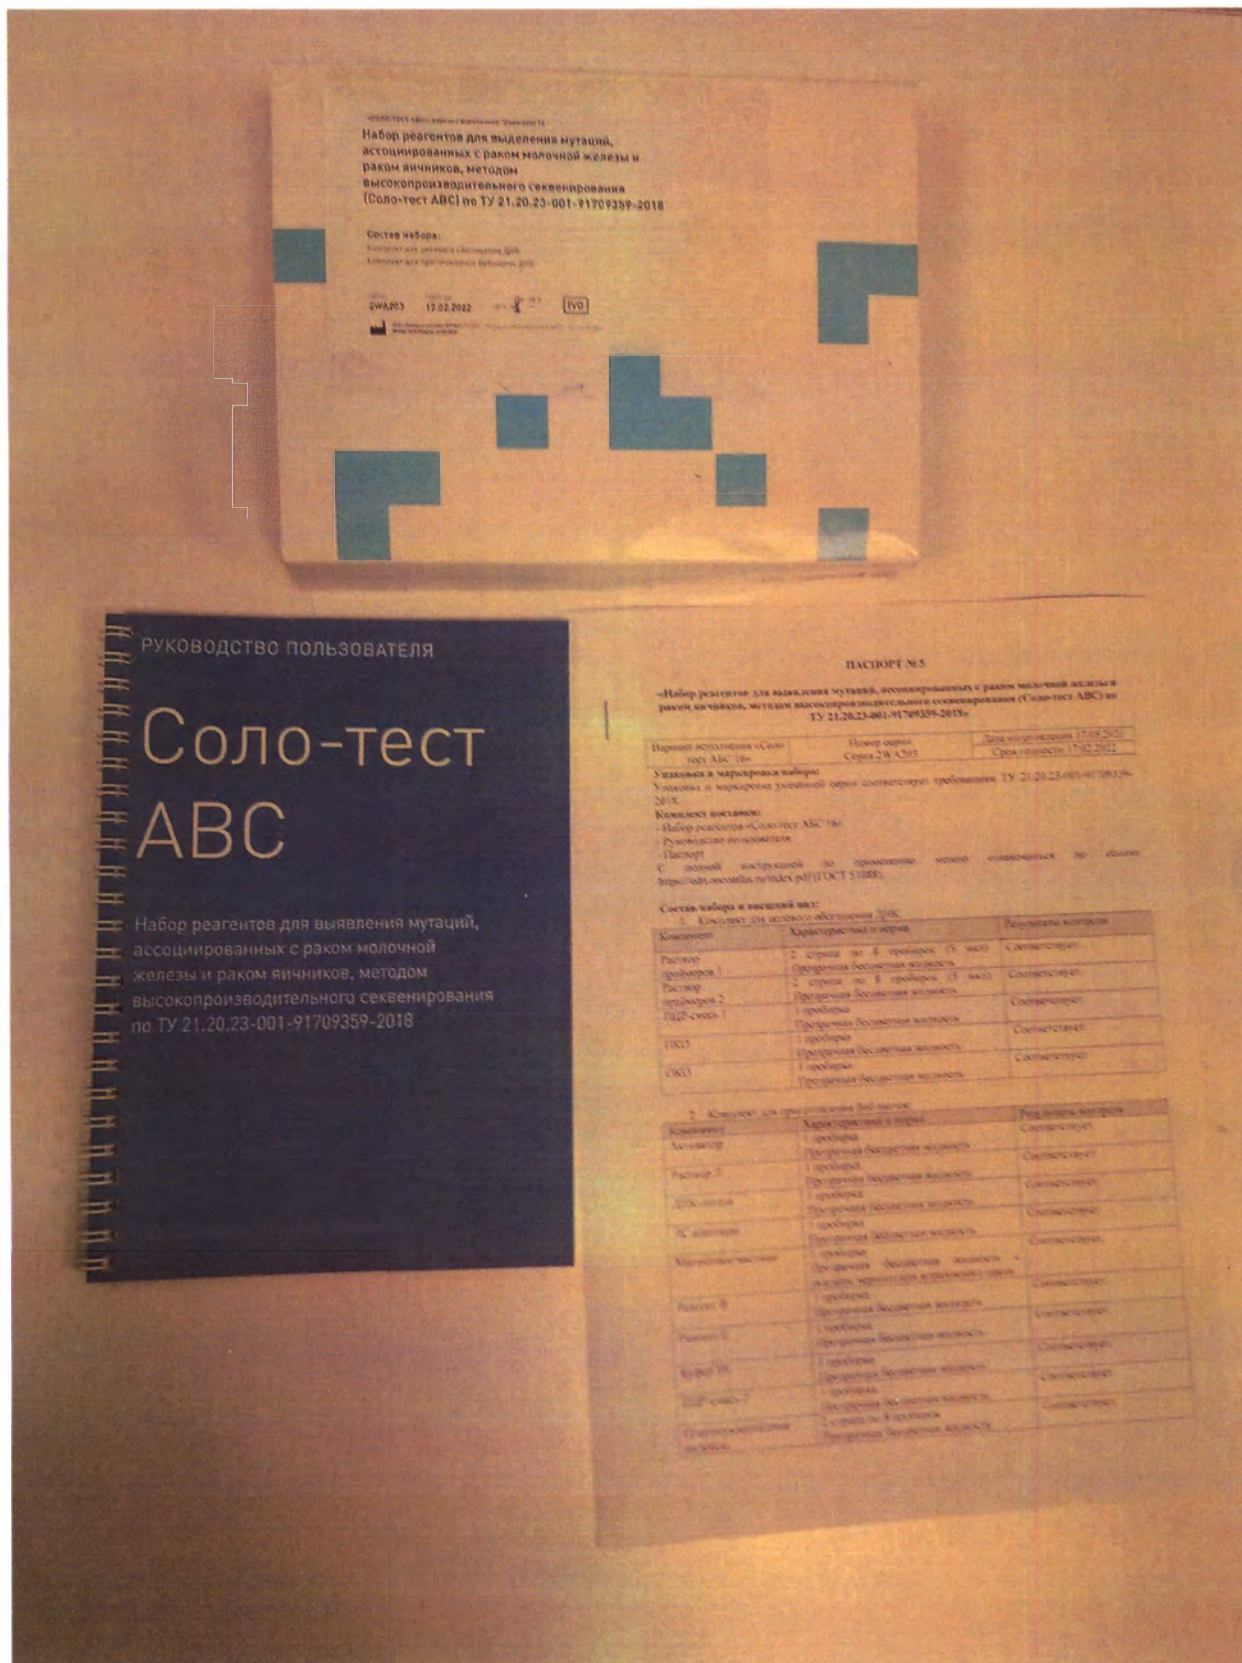


Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест ABC 16», комплект поставки




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест ABC 16», общий вид

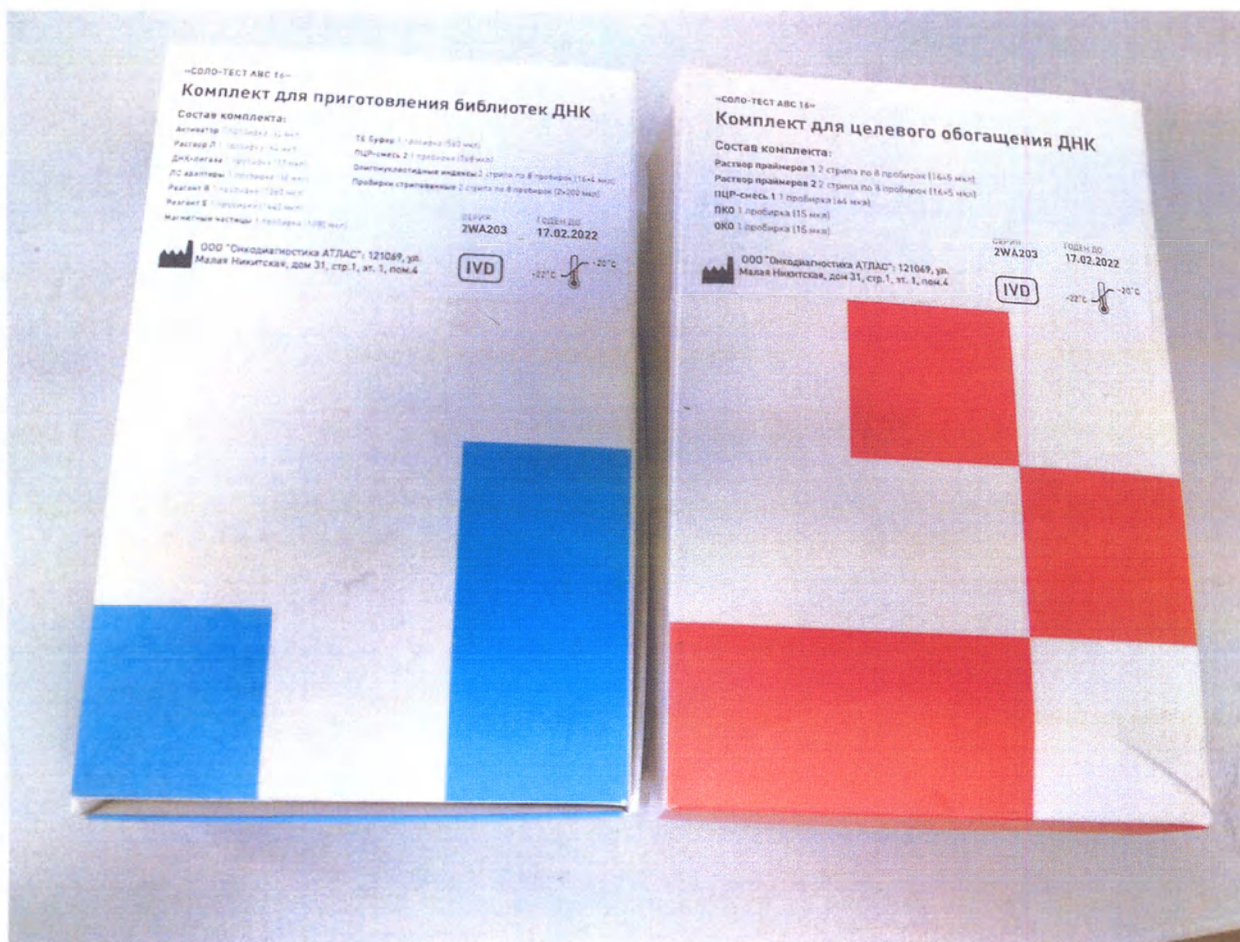

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест ABC 16», общий вид

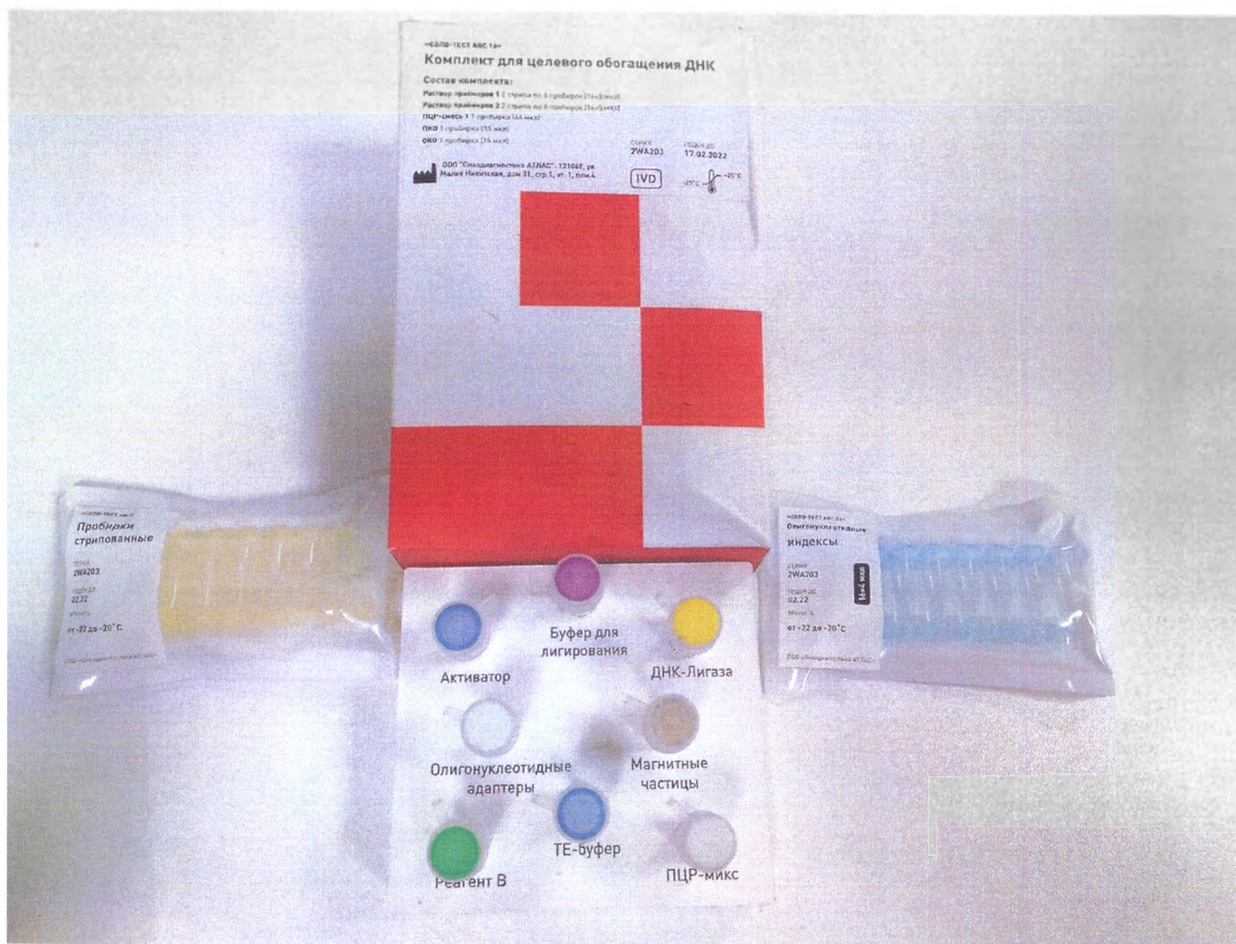

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест ABC 16», комплект для целевого обогащения ДНК

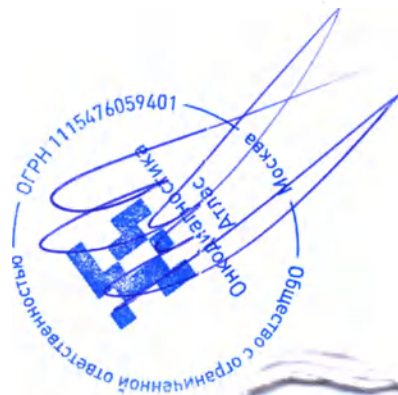

Всего листов 22

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Онкодиагностика АТЛАС»

В.А. Милейко
2021 г.



Макеты маркировки на медицинское изделие

«Набор реагентов для выявления мутаций, ассоциированных с раком молочной железы и раком яичников, методом высокопроизводительного секвенирования (Соло-тест ABC) по ТУ 21.20.23-001-91709359-2018»

«СОЛО-ТЕСТ АВС», вариант исполнения "Соло-тест 16"

**Набор реагентов для выделения мутаций,
ассоциированных с раком молочной железы и
раком яичников, методом
высокопроизводительного секвенирования
(Соло-тест АВС) по ТУ 21.20.23-001-91709359-2018**

Состав набора:

Комплект для целевого обогащения ДНК

Комплект для приготовления библиотек ДНК

СЕРИЯ

2WA203

ГОДЕН ДО

17.02.2022



ООО «Онкодиагностика АТЛАС»: 121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, дом 31, стр.1, эт. 1, пом.4
№РЗН 2020/9943 от 22.09.2020

«СОЛО-ТЕСТ ABC 16»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Состав комплекта:

Активатор 1 пробирка (32 мкл)

Раствор Д 1 пробирка (64 мкл)

ДНК-лигаза 1 пробирка (32 мкл)

ЛС адаптеры 1 пробирка (32 мкл)

Реагент В 1 пробирка (1360 мкл)

Реагент Е 1 пробирка (1440 мкл)

Магнитные частицы 1 пробирка (1280 мкл)

ТЕ Буфер 1 пробирка (560 мкл)

ПЦР-смесь 2 1 пробирка (768 мкл)

Олигонуклеотидные индексы 2 стрипа по 8 пробирок (16x4 мкл)

Пробирки стрипованные 2 стрипа по 8 пробирок (2x200 мкл)

СЕРИЯ
2WA203

ГОДЕН ДО
17.02.2022

ООО "Онкодиагностика АТЛАС": 121069, ул.
Малая Никитская, дом 31, стр.1, эт. 1, пом.4



«СОЛО-ТЕСТ ABC 16»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Состав комплекта:

Раствор праймеров 1 2 стрипа по 8 пробирок (16x5 мкл)

Раствор праймеров 2 2 стрипа по 8 пробирок (16x5 мкл)

ПЦР-смесь 1 1 пробирка (64 мкл)

ПКО 1 пробирка (15 мкл)

ОКО 1 пробирка (15 мкл)

СЕРИЯ
2WA203

ГОДЕН ДО
17.02.2022

ООО "Онкодиагностика АТЛАС": 121069, ул.
Малая Никитская, дом 31, стр.1, эт. 1, пом.4



«СОЛО-ТЕСТ АВС»

Раствор праймеров 1

СЕРИЯ
2WA203

ГОДЕН ДО
02.22

ХРАНИТЬ

от -22 до -20 °С

ООО «Онкодиагностика АТЛАС»

16x5 мкл

«СОЛО-ТЕСТ АВС»

Раствор праймеров 2

СЕРИЯ
2WA203

ГОДЕН ДО
02.22

ХРАНИТЬ

от -22 до -20 °С

ООО «Онкодиагностика АТЛАС»

16x5 мкл

«СОЛО-ТЕСТ АВС»

Олигонуклеотидные

индексы

СЕРИЯ
2WA203

ГОДЕН ДО
02.22

ХРАНИТЬ

**от -22
до -20 °С**

ООО «Онкодиагностика АТЛАС»

16x4 мкл

«СОЛО-ТЕСТ АВС»

Пробирки стрипованные

СЕРИЯ
2WA203

ГОДЕН ДО
02.22

ХРАНИТЬ

от -22 до -20 °С

ООО «Онкодиагностика АТЛАС»

«СОЛО-ТЕСТ ABC», вариант исполнения "Соло-тест 48С-6"

**Набор реагентов для выявления мутаций,
ассоциированных с раком молочной железы и раком
яичников, методом высокопроизводительного
секвенирования (Соло-тест ABC) по
ТУ 21.20.23-001-91709359-2018**

Состав набора:

Комплект для целевого обогащения ДНК

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Комплект для подготовки образца к секвенированию

Комплект для секвенирования

СЕРИЯ
2WA203

ГОДЕН ДО
17.02.2022

-22°C  -20°C

IVD



ООО "Онкодиагностика АТЛАС": 121069, ул. Малая Никитская, дом 31, стр.1, эт. 1, пом.4
№РЗН 2020/9943 от 22.09.2020

«СОЛО-ТЕСТ АВС 48С-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Состав комплекта:

Раствор праймеров 1 1 пробирка (240 мкл)

Раствор праймеров 2 1 пробирка (240 мкл)

ПЦР-смесь 1 1 пробирка (192 мкл)

ПКО 1 пробирка (24 мкл)

ОКО 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
2WA203

ГОДЕН ДО
17.02.2022

-22°C



-20°C

IVD



ООО «Инновационные АТ-АС» 12049 ул. Мухоморова д. 10 стр. 1, пом. 6

«СОЛО-ТЕСТ АВС 48С-Б»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Состав комплекта:

Активатор 1 пробирка (96 мкл)

Раствор Л 1 пробирка (192 мкл)

ДНК-лигаза 1 пробирка (96 мкл)

ЛС адаптеры 1 пробирка (96 мкл)

Магнитные частицы 1 пробирка (3840 мкл)

Реагент В 1 пробирка (4500 мкл)

Реагент Е 1 пробирка (4500 мкл)

ТЕ Буфер 2 пробирки (2 × 4500 мкл)

ПЦР-смесь 2 2 пробирки (2 × 1152 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Си-7 1 пробирка (16 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Си-8 1 пробирка (16 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Си-9 1 пробирка (16 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Си-10 1 пробирка (16 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Си-11 1 пробирка (16 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Си-12 1 пробирка (16 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-1 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-2 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-3 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-4 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-5 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-6 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-7 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-8 1 пробирка (12 мкл)



ООО "С-диагностика АТЛАС", 121069, ул. Малая Никитская, дом 31, стр.1,
эт. 1, пом.4

СЕРИЯ
2WA203

ГОДЕН ДО
17.02.2022



IVD

«СОЛО-ТЕСТ АВС 48С-Б»

Комплект для подготовки образца к секвенированию

Состав комплекта:

Раствор НТ1 1 пробирка (5 мл)

Картридж 1 шт. (35 мл)

СЕРИЯ
2WA203

ГОДЕН ДО
17.02.2022



IVD



ООО "Онкодиагностика АТЛАС": 121069, ул. Малая Якимовская, дом 31, стр.1, эт. 1,
пом.4

«СОЛО-ТЕСТ АВС 48С-Б»

Комплект для секвенирования

Состав комплекта:

Раствор PR2 1 бутыль (500 мл)

Проточная кювета 1 шт.

СЕРИЯ
2WA203

ГОДЕН ДО
17.02.2022



ООО "Онкодиагностика АТЛАС": 121069, ул. Малая Никитская, дом 31, стр.1,
эт. 1, пом.4

«СЕРЛО-ТЕСТ АРС»
Олигонуклеотидные
индексы: **ЛИ-5**
«СЕРЛО»
ZWA263 12 МКЛ
«СЕРЛО»
82.22 ХРАНИТЬ
-22...-20 °С
УОО «СЕРЛО» ЗАКРЕПЛЕНО НА АТЛАСЕ

Раствор праймеров 1

СЕРИЯ ZWA283	
ТЭМП РАБОТЫ 02.22	ТЕМП ХРАНИЛ. -22...-20°C

ООО «ДОНСКОЕ» АДХС ВЛАДИКАВКАЗ

«СНГ-ТЕСТ ABC»
Раствор
праймеров 2
2WAZ289
02.22
-22...-20°C

OKO

ZWA203

02.22

-22...-28°C

КОЛО-ТЕСТ АБСН

ПЦР-смесь 1

2WA203

02.22

22...-20°C

Активатор

Модель: **ZWA203**

Температура: **-22...+20 °C**

ДНК-лигаза

ZWA293

02.22

22...28 °C

«СРО-ТЕСТ АВО»
ЛС адаптеры
2WA203
02.22
-22...+20 °C

**Магнитные
частицы**

Реагент В

2WA203

02.22

ИПА 203

-22...-20°C

Реагент Е

СЕРИЯ
2WA203

ГОДИН ДО
02.22

4500 мкл

X-ANALIS
-22...-20 °C

PCR-смесь 2

«СН-7»
Олигонуклеотидные
индексы: **СИ-7**
ZWA283
02.22 -22...-20°C

Олигонуклеотидные
индексы: СИ-8

«СОР-ТЕСТ АРС»
Оптимизированные
индексы: СИ-9
2WA283
02.22
22...24°C

«СОЛО-ТЕСТ АРС»
Олигонуклеотидные
индексы: СИ-10

1-й тип
2WA203

2-й тип
02.22

3-й тип
-22...-29°C

«СИМ-ТЕСТ АВО»

**Олигонуклеотидные
индексы: СИ-12**

Т-ИЧК

ZWA203

Время: 02.22

КДН: -22...+28 °C

Олигонуклеотидные
индексы: ЛН-1

«СОЮЗ-ТЕСТ АБС»
**Олигонуклеотидные
индексы: ЛИ-2**
1548
ZWA263
02.22
2020-11-11
02.22
-22...+20°C

«СОЛО-ТЕСТ АМС»

Олигонуклеотидные
индексы: ЛМ-3

2WA203

62.22

И-А3-А11

-22...-20°C

«СВЕТ-ТЕСТ АМС»

Одноклассовые
индексы: ЛИ-4

Л.И.ЗВ
2WA283

41 А 32

82,22 -22...-20°C

Олигонуклеотидные
индексы: ЛН-6

—СОЛО-ТЕСТ АВС—
Оптимизированные
индексы: ЛИ-7
1.1.201
2WA203
02.22
-22...-26°C

«СЕРВ-ТЕСТ АМС»
Олигонуклеотидные
индексы: ЛН-8
ZWA293
62.22
-22...-20°C

«СОЛО-ТЕСТ ABC», вариант исполнения "Соло-тест ABC 48С-а"

**Набор реагентов для выявления мутаций,
ассоциированных с раком молочной железы и раком
яичников, методом высокопроизводительного
секвенирования
(Соло-тест ABC) по ТУ 21.20.23-001-91709359-2018**

Состав набора:

Комплект для целевого обогащения ДНК

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Комплект для подготовки образца к секвенированию


Комплект для секвенирования

СЕРИЯ

2WA203

ГОДЕН ДО

17.02.2022



IVD



ООО "Онкодиагностика АТЛАС": 121069, ул. Малая Никитская, дом 31, стр.1, эт. 1, пом.4

№РЭН 2020/9943 от 22.09.2020

«СОЛО-ТЕСТ АВС 48С-А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Состав комплекта:

Раствор праймеров 1 1 пробирка (240 мкл)

Раствор праймеров 2 1 пробирка (240 мкл)

ПЦР-смесь 1 1 пробирка (192 мкл)

ПКО 1 пробирка (24 мкл)

ОКО 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ
2WA203

ГОДЕН ДО
17.02.2022



IVD



ООО «Скандинавская АТЛАС» 117069, г. Москва, Никитский бульвар, д. 31, стр. 1, 1 этаж

«СОЛО-ТЕСТ АВС 48С-А»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Состав комплекта:

Активатор 1 пробирка (96 мкл)

Раствор Л 1 пробирка (192 мкл)

ДНК-лигаза 1 пробирка (96 мкл)

ЛС адаптеры 1 пробирка (96 мкл)

Магнитные частицы 1 пробирка (3840 мкл)

Реагент В 1 пробирка (4500 мкл)

Реагент Е 1 пробирка (4500 мкл)

ТЕ Буфер 2 пробирки (2 × 4500 мкл)

ПЦР-смесь 2 2 пробирки (2 × 1152 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Си-1 1 пробирка (16 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Си-2 1 пробирка (16 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Си-3 1 пробирка (16 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Си-4 1 пробирка (16 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Си-5 1 пробирка (16 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Си-6 1 пробирка (16 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-1 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-2 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-3 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-4 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-5 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-6 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-7 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-8 1 пробирка (12 мкл)



ООО "Биокодиagnostика АТЛАС": 121049, ул. Малая Никитская, дом 3Т, стр. 1,
эт. 1, пом. 4

СЕРИЯ
2WA203

ГОДЕН ДО
17.02.2022



IVD

«СОЛО-ТЕСТ АВС 48С-А»

Комплект для подготовки образца к секвенированию

Состав комплекта:

Раствор НТ1 1 пробирка (5 мл)

Картридж 1 шт. (35 мл)

СЕРИЯ
2WA203

ГОДЕН ДО
17.02.2022



IVD



ООО "Онкодиагностика АТЛАС" 121069, ул. Малая Никитская, дом 31, стр. 1, эт. 1, пом. 4

«СОЛО-ТЕСТ АВС 48С-А»

Комплект для секвенирования

Состав комплекта:

Раствор PR2 1 бутыль (500 мл)

Проточная кювета 1 шт.

СЕРИЯ
2WA203





ГОДЕН ДО
17.02.2022



IVD



ООО "Онкодиагностика АТЛАС": 121069, ул. Малая Никитская, дом 31,
стр.1, эт. 1, пом.4



«СОЛО-ТЕСТ АВС», вариант исполнения "Соло-тест 48-а"

Набор реагентов для выявления мутаций, ассоциированных с раком молочной железы и раком яичников, методом высокопроизводительного секвенирования (Соло-тест АВС) по ТУ 21.20.23-001-91709359-2018

Состав набора:

1) Комплект для целевого обогащения ДНК

2) Комплект для приготовления библиотек ДНК:

- Активатор 1 пробирка (96 мкл)
- Раствор Л 1 пробирка (192 мкл)
- ДНК-лигаза 1 пробирка (96 мкл)
- ЛС адаптеры 1 пробирка (96 мкл)
- Магнитные частицы 1 пробирка (3840 мкл)
- Реагент В 1 пробирка (4500 мкл)
- Реагент Е 1 пробирка (4500 мкл)
- ТЕ Буфер 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
- ПЦР-смесь 2 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-1 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-2 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-3 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-4 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-5 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-6 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-1 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-2 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-3 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-4 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-5 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-6 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-7 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-8 1 пробирка (12 мкл)



ООО "Онкодиагностика АТЛАС": 121069, ул. Малая
Никитская, дом 31, стр.1, эт. 1, пом.4

ИРЗН 2020/9943 от 22.09.2020

СЕРИЯ
2WA203

ГОДА ВЫП.
17.02.2022



TEST ABC--

10

WVA203

02.22

24 мкл

-22...-20°C

—СОЛО-ТЕСТ АВС—

**Раствор
праймеров 1**

СЕРИЯ
2WA203

240 мкл

02.22 **-22...-20°C**

Содержит 1 флакон с 1 мл раствора праймеров 1 и 1 флакон с 1 мл раствора праймеров 2.

СОЛО-ТЕСТ АВС

**Раствор
праймеров 2**

2WA203 240 мкл

02.22 -22...-20°C

КОЛО-ТЕСТ АРС®
ОКО
 2WA203
 02.22
 24 МЛ
 ХРАНИТЬ
 -22...-20°C

ПЦР-смесь 1

2WA203 192 мкл

02.22 ХРАНИТЬ -22...-20 °C

КОЛО-ТЕСТ АВТО

Активатор

2WA203

02.22 -22...-20°C

СОЛС-ТЕСТ АВС-11

Раствор Л

2WA203 192 мкл

02.22 -22...-20 °C

«ССЛО-ТЕСТ АБС»
ДНК-лигаза
2WA203
02.22
10-15° -
-22...-20°C
Шт. 1000, адрес: ул. А.С.Бака

«СОЛО-ТЕСТ АВС»
ЛС адаптеры
2WA203 96 МКЛ
ХАНИТЬ
02.22 -22...-20°C
ООО «Бюджетный ТехАтлас»

СОЛО-ТЕСТ АВС

**Магнитные
частицы**

2WA203 3840 мкл

02.22 -22...-20°C

РЕАГЕНТ В

2WAZ03 02.22

ТЕ Буфер

2WA203 **4500 мкл**

02.22 **-22...-20°С**

—СОЛО-ТЕСТАРС—

ПЦР-смесь 2

2WA203 **1152 мкл**

02.22 **-22...-20°C**

ПЦР-Смесь для амплификации ДНК

Олигонуклеотидные
индексы: СИ-1

2WA203 16 мкл

02.22 -22...-20°C

Олигонуклеотидные
индексы: СИ-2

2WA203

16 МКЛ

02.22

ХРАНИТЬ
-22...-20 °С

СИ-2 Олигонуклеотиды АТЛАС

Олигонуклеотидные
индексы: СИ-3

Олигонуклеотидные
индексы: СИ-4

2WA203 16 мкл

02.22 -22...-20°C

Олигонуклеотидные
индексы: СИ-5

2WA203 16 мкл

02.22 ХРАНИТЬ
-22...-20°С

ТИПО АТЛАС

Олигонуклеотидные
индексы: СИ-6

ZWA203 16 мкл

02.22 -22...-20°C

«СОЛО-ТЕСТ ABC»
Олигонуклеотидные
индексы: ЛИ-1
ZWA203
02.22 -22...-20°C
ООО «Биофарма» г. Москва

Олигонуклеотидные
индексы: ЛИ-2

Олигонуклеотидные
индексы: ЛИ-3

2WA203 12 мкл

02.22 -22...-20°C

Олигонуклеотидные
индексы: ЛИ-4

2WA203 12 мкл

02.22 -22...-20°C

Олигонуклеотидные
индексы: ЛИ-5
2WA203 12 мкл
02.22 -22...-20°C

Олигонуклеотидные
индексы: ЛИ-6

2WA203 12 мкл

02.22 -22...-20°C

Олигонуклеотидные
индексы: ЛИ-7

2WA203 12 мкл

02.22 -22...-20°C

Олигонуклеотидные
индексы: ЛН-8

2WA203 12 мкл

02.22 -22...-20°C

«СОЛО-ТЕСТ АВС 48-Б»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Состав комплекта:

Раствор праймеров 1 1 пробирка [240 мкл]

Раствор праймеров 2 1 пробирка [240 мкл]

ПЦР-смесь 1 1 пробирка [192 мкл]

ПКО 1 пробирка [24 мкл]

ОКО 1 пробирка [24 мкл]

СЕРИЯ
2WA203

ГОДЕН ДО
17.02.2022



IVD



ООО "Онкодиагностика АТЛАС": 121069, ул. Малая
Никитская, дом 31, стр.1, эт. 1, пом.4

«СОЛО-ТЕСТ АВС», вариант исполнения "Соло-тест 48-6"

Набор реагентов для выявления мутаций, ассоциированных с раком молочной железы и раком яичников, методом высокопроизводительного секвенирования (Соло-тест АВС) по ТУ 21.20.23-001-91709359-2018

Состав набора:

1) Комплект для целевого обогащения ДНК

2) Комплект для приготовления библиотек ДНК:

- Активатор 1 пробирка (96 мкл)
- Раствор Л 1 пробирка (192 мкл)
- ДНК-лигаза 1 пробирка (96 мкл)
- ЛС адаптеры 1 пробирка (96 мкл)
- Магнитные частицы 1 пробирка (3840 мкл)
- Реагент В 1 пробирка (4500 мкл)
- Реагент Е 1 пробирка (4500 мкл)
- ТЕ Буфер 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
- ПЦР-смесь 2 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-7 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-8 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-9 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-10 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-11 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-12 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-1 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-2 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-3 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-4 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-5 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-6 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-7 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-8 1 пробирка (12 мкл)



ООО "Онкодиагностика АТЛАС": 121069, ул. Малая
Никитская, дом 31, стр.1, эт. 1, пом.4
№ РЭН 2020/9943 от 22.09.2020

СЕРИЯ
2WA203

ГОДА ИЗД.
17.02.2022

-22 °C  -20 °C

IVD

«СОЛО-ТЕСТ АВС 48-А»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Состав комплекта:

Раствор праймеров 1 1 пробирка (240 мкл)

Раствор праймеров 2 1 пробирка (240 мкл)

ПЦР-смесь 1 1 пробирка (192 мкл)

ПКО 1 пробирка (24 мкл)

ОКО 1 пробирка (24 мкл)

Серия
2WA203

Срок годности
17.02.2022

-20°C



IVD



Исключительные права на использование товарного знака принадлежат ООО ЦРПМ

«СОЛО-ТЕСТ АВС»

Картридж

35 мл

СЕРИЯ ГОДЕН ДО ХРАНИТЬ
2WA203 02.22 от -22 до -20°C

ООО «Онкодиагностика АТЛАС»

«СОЛО-ТЕСТ АВС»

Раствор НТ1

5 мл

СЕРИЯ ГОДЕН ДО ХРАНИТЬ
2WA203 02.22 -22 до -20°C

ООО «Онкодиагностика АТЛАС»

«СОЛО-ТЕСТ АВС»

Раствор PR2

СЕРИЯ
2WA203

ГОДЕН ДО
02.22

ХРАНИТЬ

от 2 до 8°C

ООО «Онкодиагностика АТЛАС»

«СОЛО-ТЕСТ АВС»

Проточная кювета

СЕРИЯ ГОДЕН ДО ХРАНИТЬ
2WA203 02.22 от 2 до 8°C

500 мл



Всего листов 13