

УТВЕРЖДАЮ


Директор
ООО «Онкодиагностика АТЛАС»

В.А. Милейко
2022 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

«Набор реагентов для одновременного выявления мутаций в генах BRAF, EGFR, KRAS, NRAS, KIT, PDGFRA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, методом высокопроизводительного секвенирования (Соло-тест Атлас) по ТУ 21.20.23-002-91709359-2018»

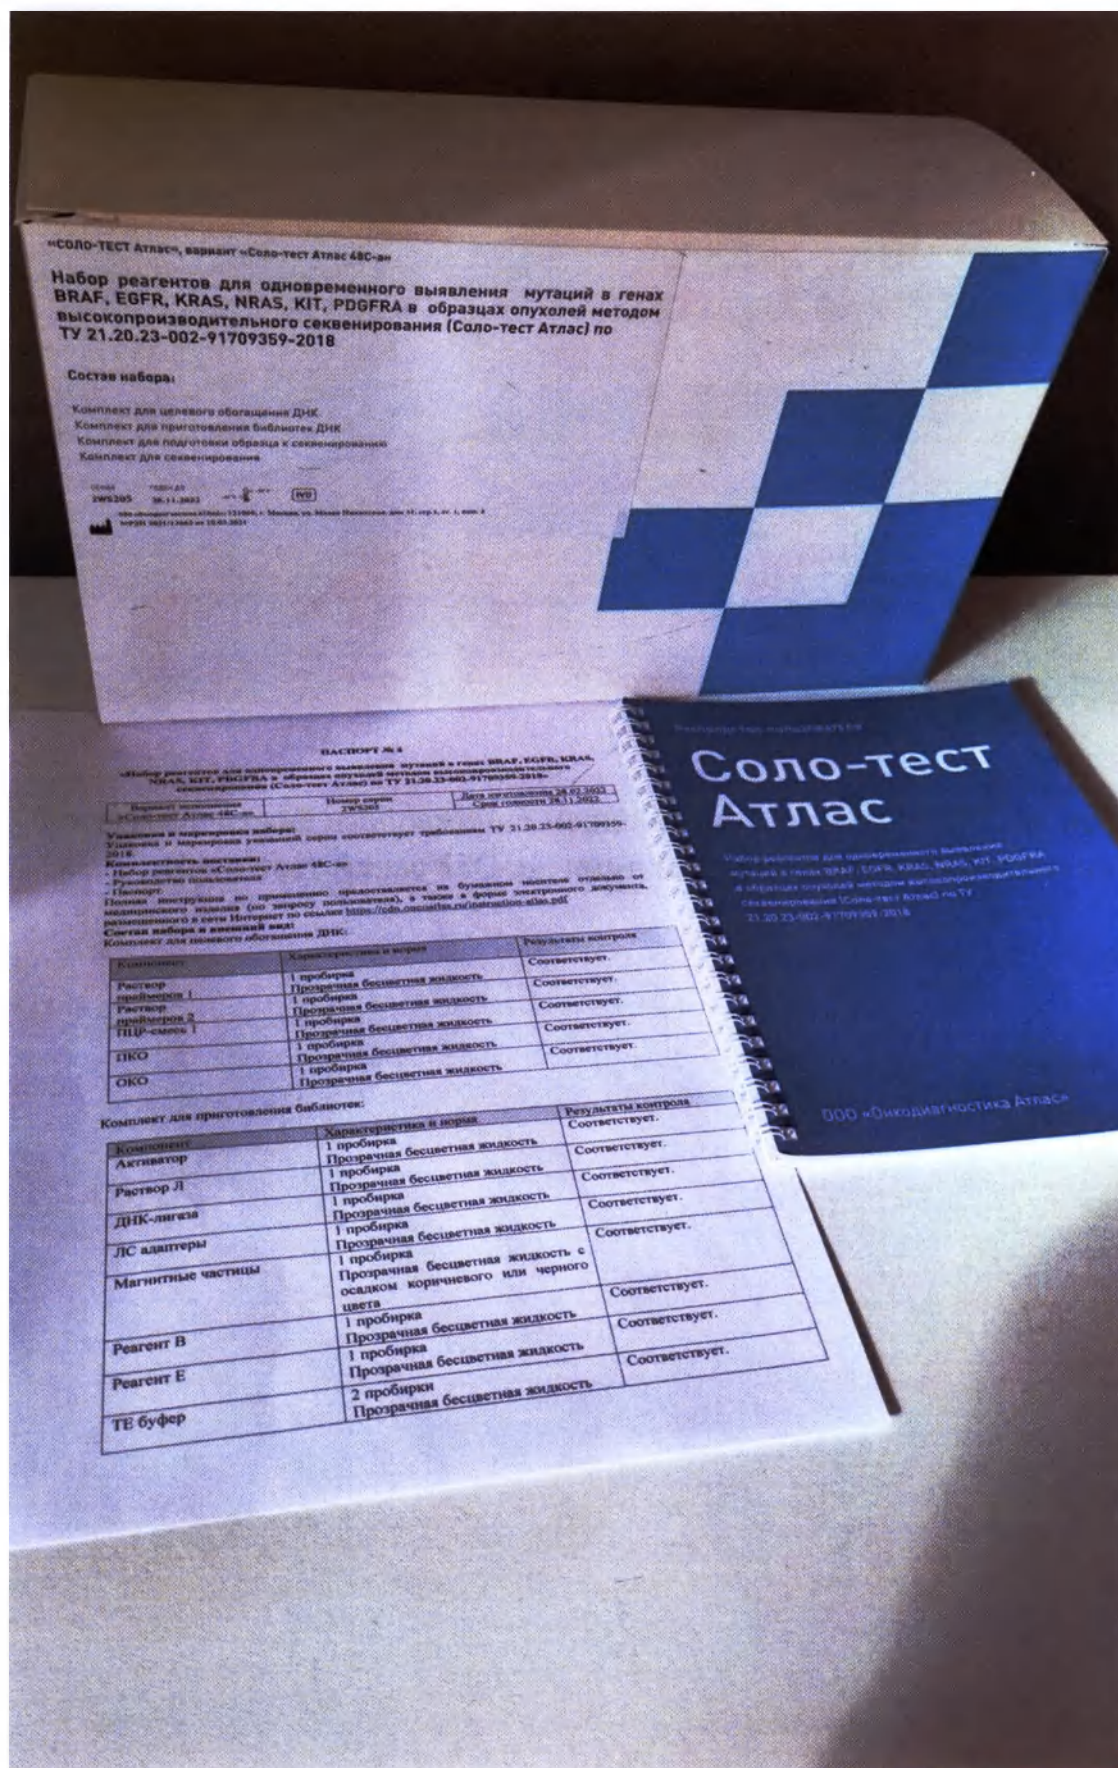

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест Атлас 48С-а»: комплект поставки



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения
«Соло-тест Атлас 48С-а»: комплект для целевого обогащения




Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест Атлас 48С-а»: комплект для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест Атлас 48С-а»: комплект для секвенирования



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест Атлас 48С-а»: комплект для подготовки образца к секвенированию

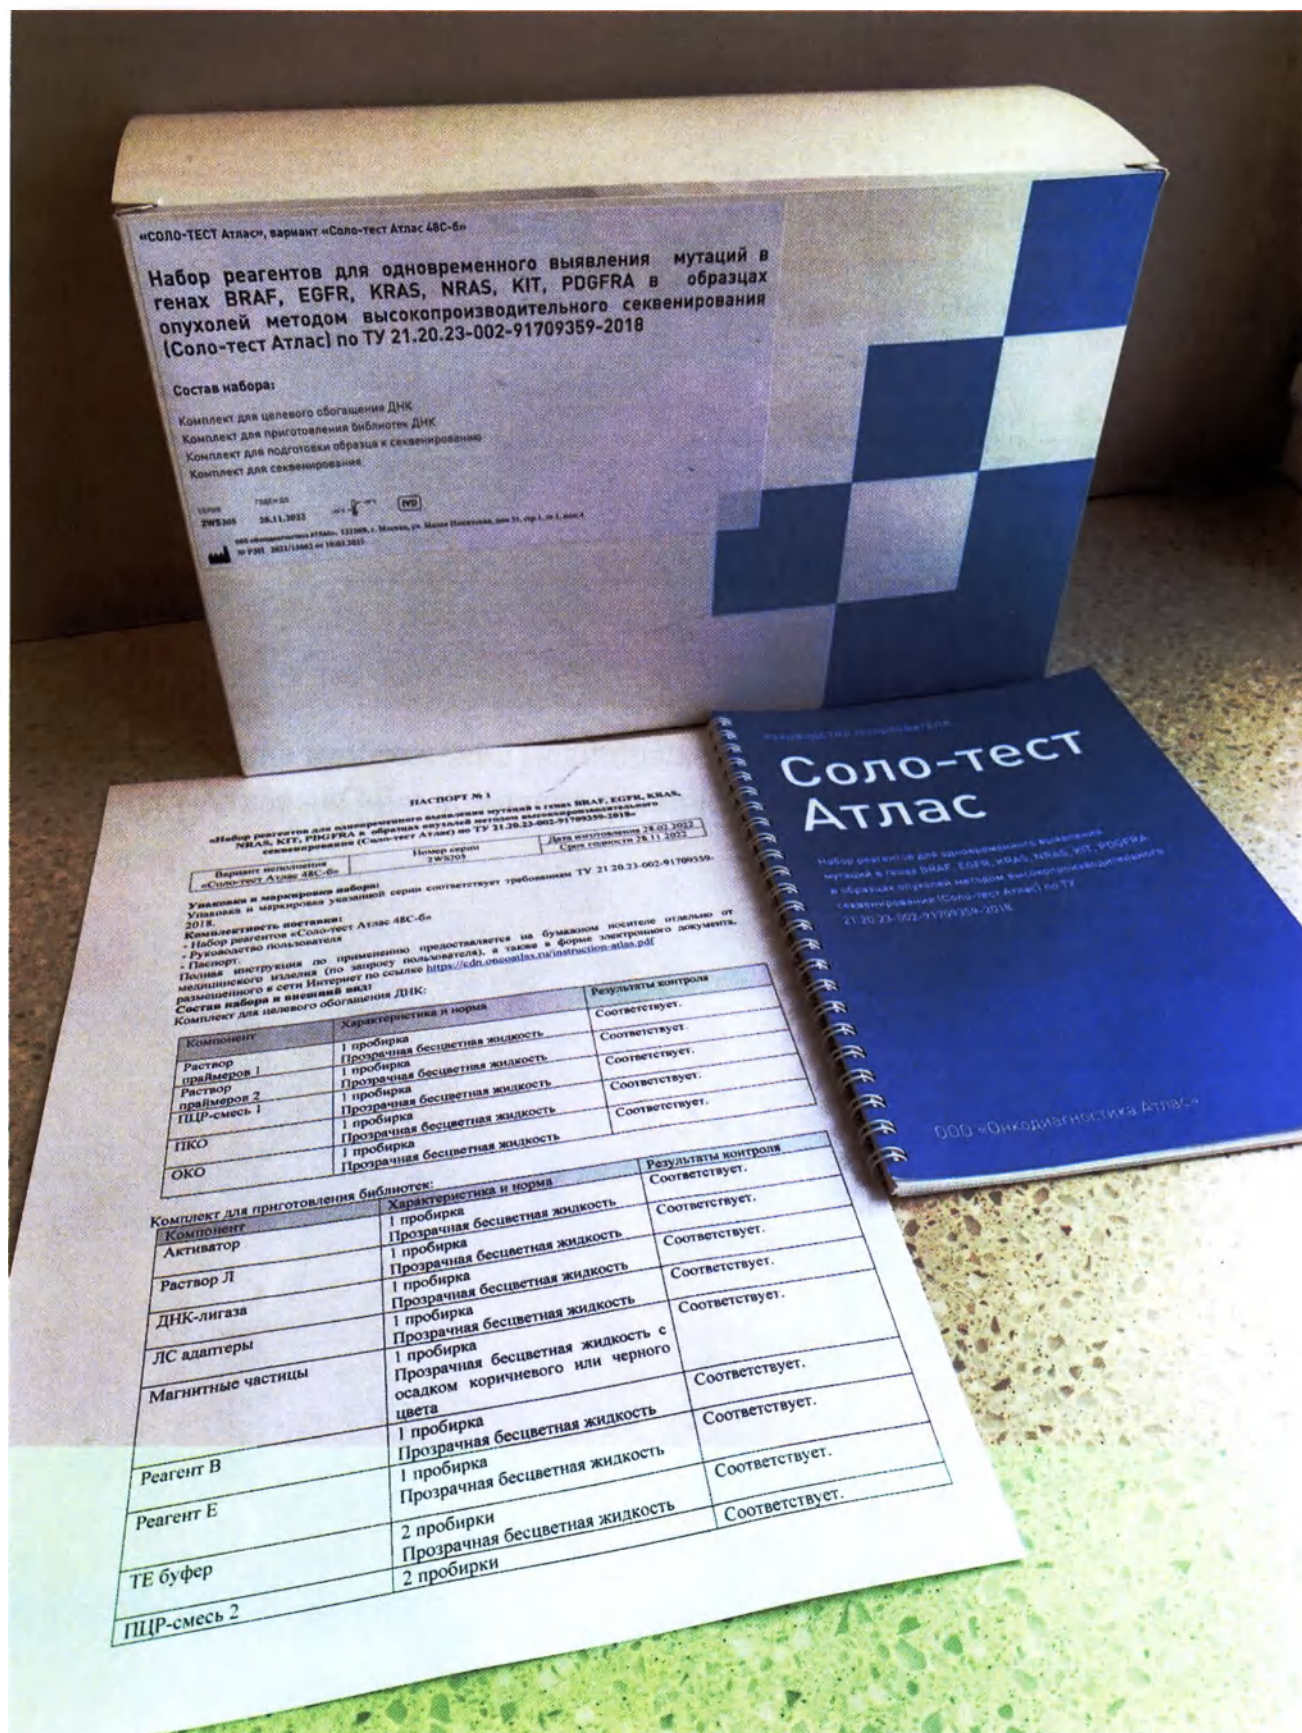

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест Атлас 48С-б»: комплект поставки



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест Атлас 48С-б»: комплект для приготовления библиотек ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест Атлас 48С-б»: комплект для целевого обогащения ДНК



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест Атлас 48С-б»: комплект для подготовки образца к секвенированию



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения
«Соло-тест Атлас 48С-б»: комплект для секвенирования

«СОЛО-ТЕСТ Атлас», вариант «Соло-тест Атлас 48-а»

Набор реагентов для одновременного выявления мутаций в генах BRAF, EGFR, KRAS, NRAS, KIT, PDGFRA в образцах опухолей методом высокопроизводительного секвенирования (Соло-тест Атлас) по ТУ 21.20.23-002-91709359-2018

Состав набора:

- 1) Комплект для целевого обогащения ДНК
- 2) Комплект для приготовления библиотек ДНК:

- Активатор 1 пробирка (96 мкл)
- Раствор Л 1 пробирка (192 мкл)
- ДНК-лигаза 1 пробирка (96 мкл)
- ЛС адаптеры 1 пробирка (96 мкл)
- Магнитные частицы 1 пробирка (3840 мкл)
- Реагент В 1 пробирка (4500 мкл)
- Реагент Е 1 пробирка (4500 мкл)
- ТЕ буфер 2 пробирки (2 × 4500 мкл)
- ПЦР-смесь 2 2 пробирки (2 × 1152 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-1 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-2 1 пробирка (16 мкл)

- Олигонуклеотидные индексы Си-3 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-4 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-5 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-6 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-1 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-2 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-3 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-4 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-5 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-6 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-7 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-8 1 пробирка (12 мкл)

ООО «Онкодиагностика Атлас» 121069, Москва, ул. Малая Никитская, дом 31, стр. 1, эт. 1, пом. 4

серия 2WS205 год изд. 28.11.2022
№ P3H 2021/13662 от 10.03.2021

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Соло-тест Атлас

Набор реагентов для одновременного выявления мутаций в генах BRAF, EGFR, KRAS, NRAS, KIT, PDGFRA в образцах опухолей методом высокопроизводительного секвенирования (Соло-тест Атлас) по ТУ 21.20.23-002-91709359-2018

ООО «Онкодиагностика Атлас»

«Набор реагентов для одновременного выявления мутаций в генах BRAF, EGFR, KRAS, NRAS, KIT, PDGFRA в образцах опухолей методом высокопроизводительного секвенирования (Соло-тест Атлас) по ТУ 21.20.23-002-91709359-2018»

Вариант исполнения «Соло-тест Атлас 48-а»	Номер серии 2WS205	Дата изготовления 28.02.2022 Срок годности 28.11.2022
--	-----------------------	--

Упаковка и маркировка набора:

Упаковка и маркировка указанной серии соответствует требованиям ТУ 21.20.23-002-91709359-2018.

Комплектность поставки:

- Набор реагентов «Соло-тест Атлас 48-а»
- Руководство пользователя
- Паспорт.

Полная инструкция по применению предоставляется на бумажном носителе отдельно от медицинского изделия (по запросу пользователя), а также в форме электронного документа, размещенного в сети Интернет по ссылке <https://cdn.oncoatlas.ru/instruction-atlas.pdf>

Состав набора и внешний вид:

Комплект для целевого обогащения ДНК:

Компонент	Характеристика и норма	Результаты контроля
Раствор праймеров 1	1 пробирка Прозрачная бесцветная жидкость	Соответствует.
Раствор праймеров 2	1 пробирка Прозрачная бесцветная жидкость	Соответствует.
ПЦР-смесь 1	1 пробирка Прозрачная бесцветная жидкость	Соответствует.
ПКО	1 пробирка Прозрачная бесцветная жидкость	Соответствует.
ОКО	1 пробирка Прозрачная бесцветная жидкость	Соответствует.


Комплект для приготовления библиотек:

Компонент	Характеристика и норма	Результаты контроля
Активатор	1 пробирка Прозрачная бесцветная жидкость	Соответствует.
Раствор Л	1 пробирка Прозрачная бесцветная жидкость	Соответствует.
ДНК-лигаза	1 пробирка Прозрачная бесцветная жидкость	Соответствует.
ЛС адаптеры	1 пробирка Прозрачная бесцветная жидкость	Соответствует.
Магнитные частицы	1 пробирка Прозрачная бесцветная жидкость с осадком коричневого или черного цвета	Соответствует.
Реагент В	1 пробирка Прозрачная бесцветная жидкость	Соответствует.
Реагент Е	1 пробирка Прозрачная бесцветная жидкость	Соответствует.
ТЕ буфер	2 пробирки Прозрачная бесцветная жидкость	Соответствует.
ПЦР-смесь 2	2 пробирки	Соответствует.


Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест Атлас 48-а»: комплект поставки



Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест Атлас 48-а»: комплект для приготовления библиотек ДНК, комплект для целевого обогащения

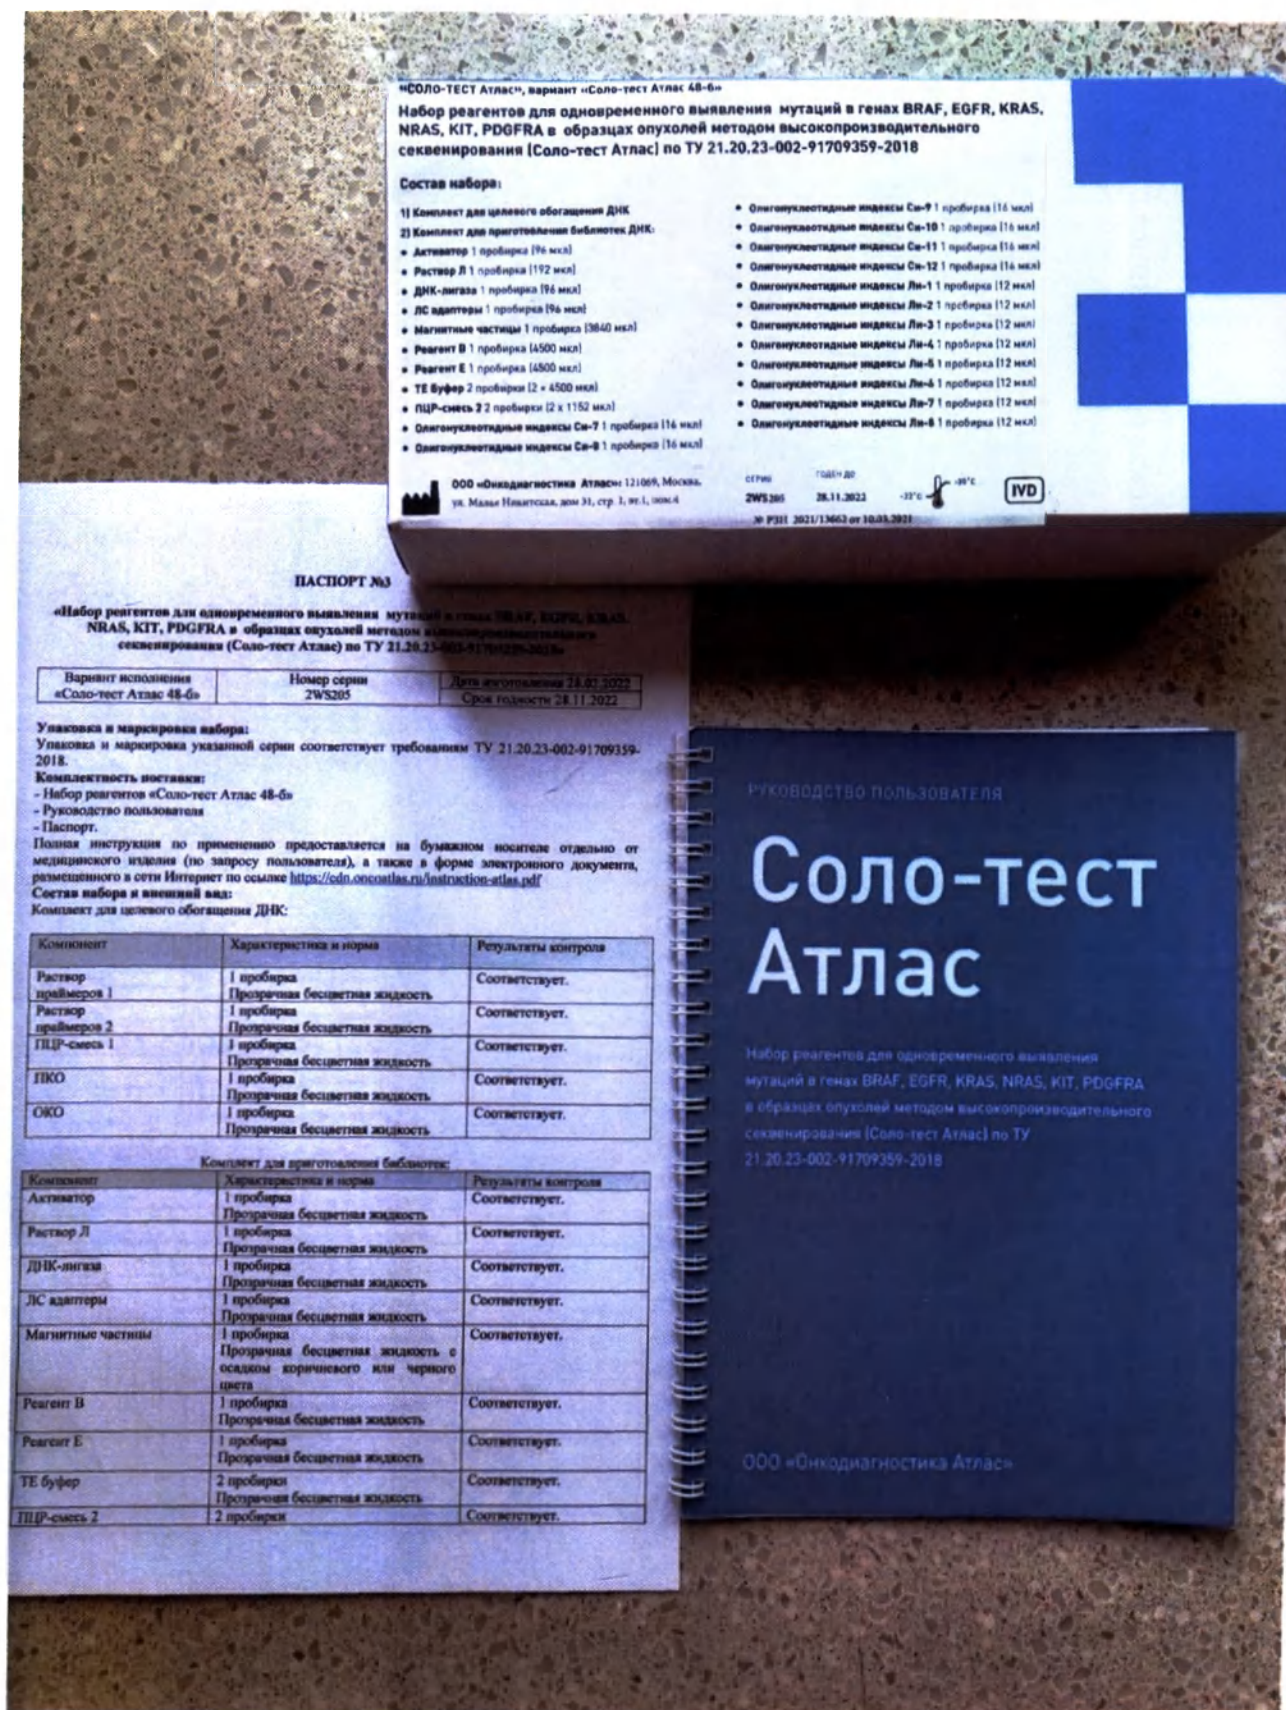


Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест Атлас 48-б»: комплект поставки

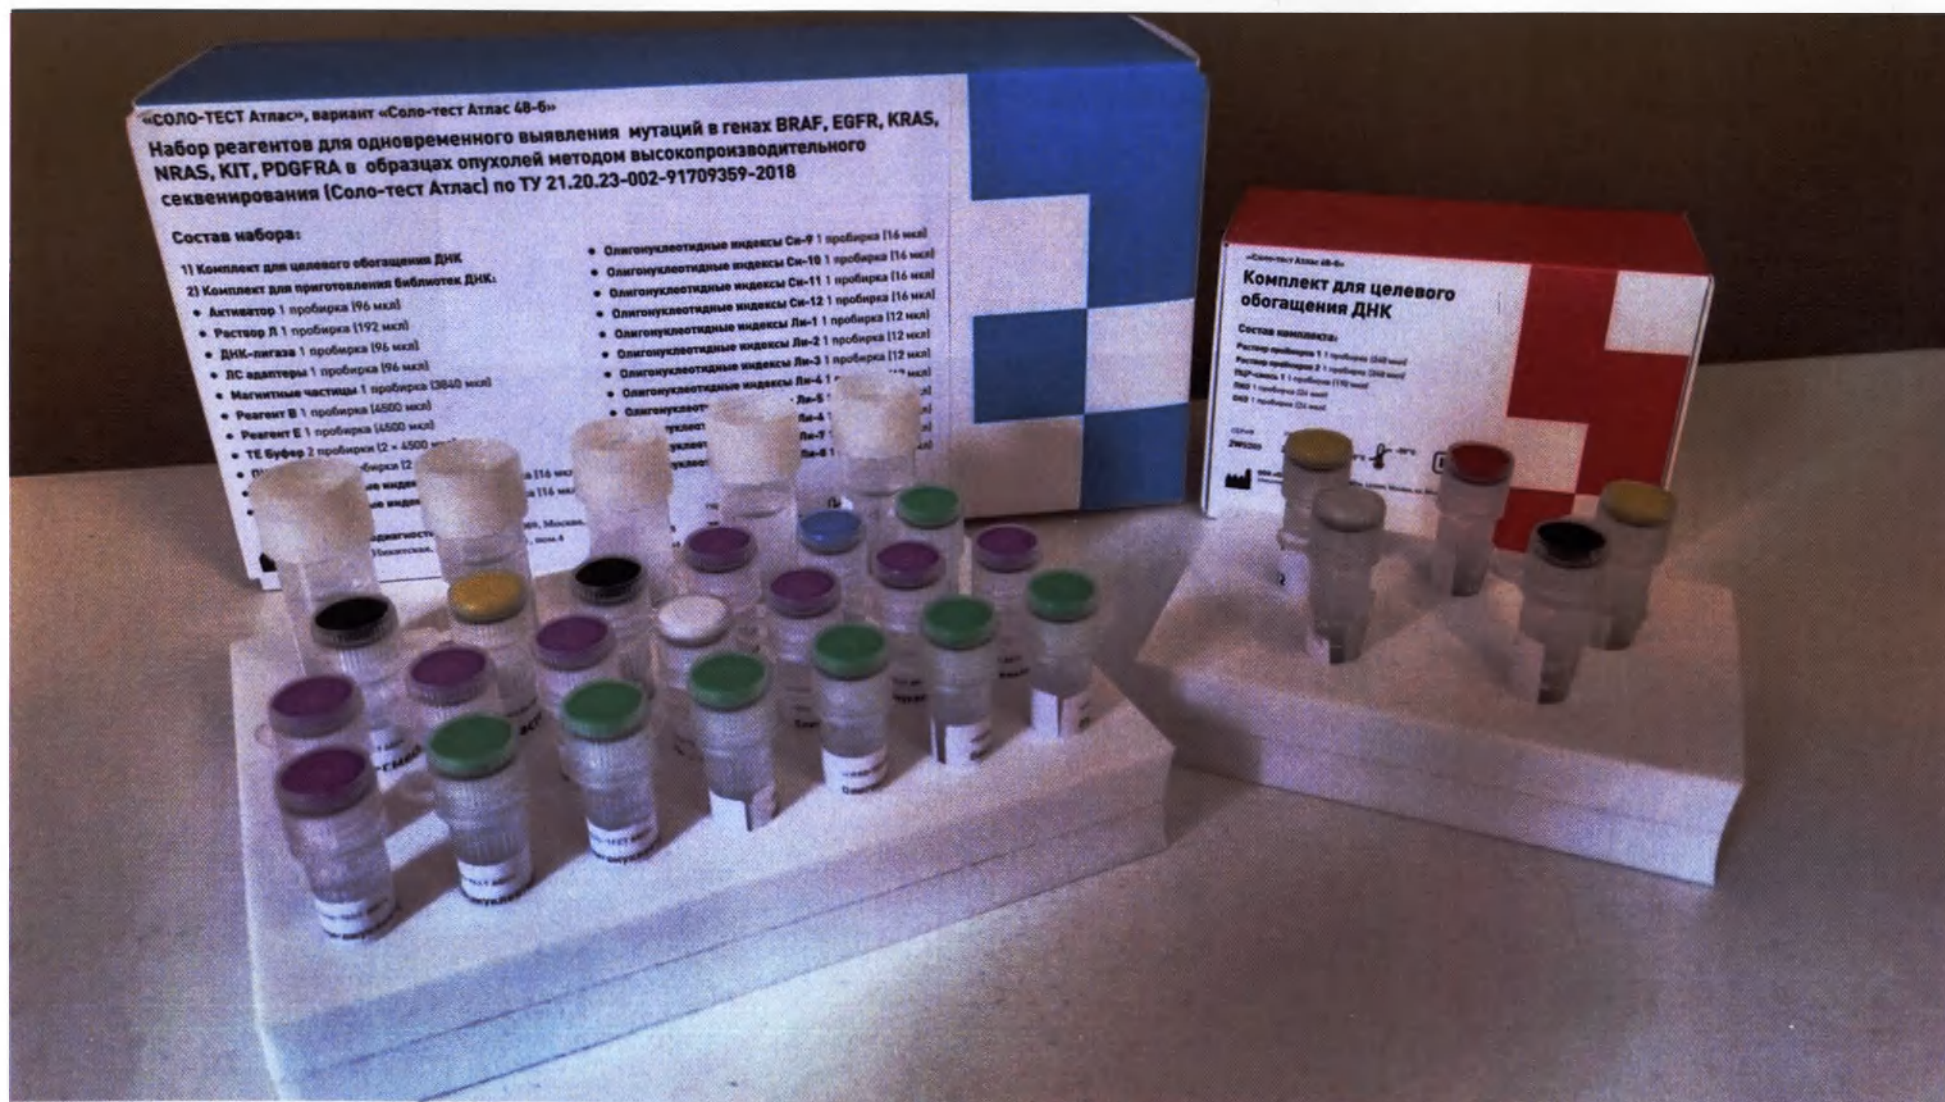

Фотографическое изображение медицинского изделия, вариант исполнения «Соло-тест Атлас 48-б»: комплект для приготовления библиотек ДНК, комплект для целового обогащения

Всего листов 15

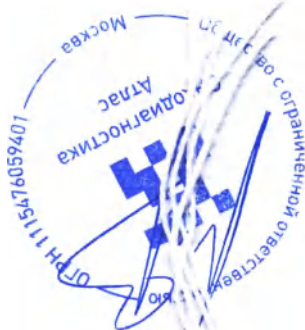

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Онкодиагностика АТЛАС»

В.А. Милейко

2022 г.



Макеты маркировки на медицинское изделие

«Набор реагентов для одновременного выявления мутаций в генах BRAF, EGFR, KRAS, NRAS, KIT, PDGFRA, ассоциированных с чувствительностью к противоопухолевой лекарственной терапии, методом высокопроизводительного секвенирования (Соло-тест Атлас) по ТУ 21.20.23-002-91709359-2018»

Макет маркировки для варианта исполнения «Соло-тест Атлас 48С-а»

«СОЛО-ТЕСТ Атлас», вариант «Соло-тест Атлас 48С-а»

Набор реагентов для одновременного выявления мутаций в генах BRAF, EGFR, KRAS, NRAS, KIT, PDGFRA в образцах опухолей методом высокопроизводительного секвенирования (Соло-тест Атлас) по ТУ 21.20.23-002-91709359-2018

Состав набора:

Комплект для целевого обогащения ДНК

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Комплект для подготовки образца к секвенированию

Комплект для секвенирования

СЕРИЯ

2WS205

ГОДЕН ДО

28.11.2022



IVD

ООО «Онкодиагностика АТЛАС»: 121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, дом 31, стр.1, эт. 1, пом. 4

№РЗН 2021/13662 от 10.03.2021



«Соло-тест Атлас 48С-а»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Состав комплекта:

Раствор праймеров 1 1 пробирка [240 мкл]

Раствор праймеров 2 1 пробирка [240 мкл]

ПЦР-смесь 1 1 пробирка [192 мкл]

ПКО 1 пробирка [24 мкл]

ОКО 1 пробирка [24 мкл]

СЕРИЯ
2WS205

ГОДЕН ДО
28.11.2022

-22°C  -20°C

IVD



ООО «Онкодиагностика АТЛАС» 171000, Апатки, ул. Молой Никитская дом 31, стр. 1, 1-й этаж

«Соло-тест Атлас 48С-а»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Состав комплекта:

Активатор 1 пробирка [96 мкл]
Раствор Л 1 пробирка [192 мкл]
ДНК-лигаза 1 пробирка [96 мкл]
ЛС адаптеры 1 пробирка [96 мкл]
Магнитные частицы 1 пробирка [3840 мкл]
Реагент В 1 пробирка [4500 мкл]
Реагент Е 1 пробирка [4500 мкл]
ТЕ Буфер 2 пробирки [2 × 4500 мкл]
ПЦР-смесь 2 2 пробирки [2 × 1152 мкл]
Олигонуклеотидные индексы Си-1 1 пробирка [16 мкл]
Олигонуклеотидные индексы Си-2 1 пробирка [16 мкл]
Олигонуклеотидные индексы Си-3 1 пробирка [16 мкл]

Олигонуклеотидные индексы Си-4 1 пробирка [16 мкл]
Олигонуклеотидные индексы Си-5 1 пробирка [16 мкл]
Олигонуклеотидные индексы Си-6 1 пробирка [16 мкл]
Олигонуклеотидные индексы Ли-1 1 пробирка [12 мкл]
Олигонуклеотидные индексы Ли-2 1 пробирка [12 мкл]
Олигонуклеотидные индексы Ли-3 1 пробирка [12 мкл]
Олигонуклеотидные индексы Ли-4 1 пробирка [12 мкл]
Олигонуклеотидные индексы Ли-5 1 пробирка [12 мкл]
Олигонуклеотидные индексы Ли-6 1 пробирка [12 мкл]
Олигонуклеотидные индексы Ли-7 1 пробирка [12 мкл]
Олигонуклеотидные индексы Ли-8 1 пробирка [12 мкл]



ООО «Онкодиагностика Атлас»: 121069, Москва, ул. Малая Пикетская, дом 31,
кв. 1, эт. 1, пом. 1

СЕРИЯ

2WS205

ГОДЕН ДО

28.11.2022



«Соло-тест Атлас 48С-а»

Комплект для подготовки образца к секвенированию

Состав комплекта:

Раствор НТ1 1 пробирка (5 мл)

Картридж 1 шт. (35 мл)

СЕРИЯ

2WS205

ГОДЕН ДО

28.11.2022



IVD



ООО «Онкодиагностика Атлас»: 121068, Москва, ул. Малая Никитская, дом 31, стр. 1, эт. 1, пом. 4

«Соло-тест Атлас 48С-а»

Комплект для секвенирования

Состав комплекта:

Раствор PR2 1 бутыль (500 мл)

Проточная кювета 1 шт.

СЕРИЯ
2WS205

ГОДЕН ДО
28.11.2022



IVD



ООО «Онкодиагност ика АТЛАС»: 121069, Москва, ул. Малая
Никитская, дом 31, стр. 1, эт.1, пом.4

«СОЛО-ТЕСТ Атлас»
Проточная

Кювета

СЕРИЯ ГОДЕН ДО ХРАНИТЬ
2WS205 11.22 от 2 до 8°C

«СОЛО-ТЕСТ Атлас»

Раствор PR2

СЕРИЯ

2WS205

ГОДЕН ДО

11.22

ХРАНИТЬ

от 2 до 8°C

ООО «Онкодиагностика АТЛАС»

500 мл

«СОЛО-ТЕСТ Атлас»

Раствор HT1

5 мл

СЕРИЯ ГОДЕН ДО ХРАНИТЬ
2WS205 11.22 -22 до -20°C

ООО «Онкодиагностика АТЛАС»

«СОЛО-ТЕСТ Атлас»

Картридж

35 мл

СЕРИЯ ГОДЕН ДО ХРАНИТЬ
2WS205 11.22 от -22 до -20°C

ООО «Онкодиагностика АТЛАС»

Макет маркировки для варианта исполнения «Соло-тест Атлас 48С-б»

«СОЛО-ТЕСТ Атлас», вариант «Соло-тест Атлас 48С-6»

Набор реагентов для одновременного выявления мутаций в генах BRAF, EGFR, KRAS, NRAS, KIT, PDGFRA в образцах опухолей методом высокопроизводительного секвенирования (Соло-тест Атлас) по ТУ 21.20.23-002-91709359-2018

Состав набора:

Комплект для целевого обогащения ДНК

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Комплект для подготовки образца к секвенированию

Комплект для секвенирования

СЕРИЯ

2WS205

ГОДЕН ДО

28.11.2022



ООО «Онкодиагностика АТЛАС»: 121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, дом 31, стр.1, эт.1, пом.4
№ РЗН 2021/13662 от 10.03.2021

«Соло-тест Атлас 48С-6»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Состав комплекта:

Раствор праймеров 1 1 пробирка (240 мкл)

Раствор праймеров 2 1 пробирка (240 мкл)

ПЦР-смесь 1 1 пробирка (192 мкл)

ПКО 1 пробирка (24 мкл)

ОКО 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ

2WS205

ГОДЕН ДО

28.11.2022

-22°C



-20°C



ООО «Онкодиагностика АТЛАС» 171009, Москва, ул. Мясной Липовицкая, дом 31, стр. 1, этаж 1000-1

«Соло-тест Атлас 48С-6»

Комплект для приготовления библиотек ДНК

Состав комплекта:

Активатор 1 пробирка (96 мкл)

Раствор Л 1 пробирка (192 мкл)

ДНК-лигаза 1 пробирка (96 мкл)

ЛС адаптеры 1 пробирка (96 мкл)

Магнитные частицы 1 пробирка (3840 мкл)

Реагент В 1 пробирка (4500 мкл)

Реагент Е 1 пробирка (4500 мкл)

ТЕ Буфер 2 пробирки (2 × 4500 мкл)

ПЦР-смесь 2 2 пробирки (2 × 1152 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Си-7 1 пробирка (16 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Си-8 1 пробирка (16 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Си-9 1 пробирка (16 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Си-10 1 пробирка (16 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Си-11 1 пробирка (16 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Си-12 1 пробирка (16 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-1 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-2 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-3 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-4 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-5 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-6 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-7 1 пробирка (12 мкл)

Олигонуклеотидные индексы Ли-8 1 пробирка (12 мкл)




ООО «Онкодиагностика Атлас» 121068, Москва, ул. Малая Пятницкая, дом 31, стр. 1, эт. 1, пом. 3

СЕРИЯ

2WS205

ГОДЕН ДО

28.11.2022



«Соло-тест Атлас 48С-6»

Комплект для подготовки образца к секвенированию

Состав комплекта:

Раствор HT1 1 пробирка (5 мл)

Картридж 1 шт. (35 мл)

СЕРИЯ

2WS205

ГОДЕ= ДО

28.11.2022



IVD



ООО «Онкодиагностика Атлас»: 121069, Москва, ул. Малая Пикитская, дом 31, стр. 1, эт.1, пом.4

«Соло-тест Атлас 48С-6»

Комплект для секвенирования

Состав комплекта:

Раствор PR2 1 бутыл (500 мл)

Проточная кювета 1 шт.

СЕРИЯ
2WS205

ГОДЕН ДО
28.11.2022



ООО «Онкодиагностика АТЛАС»: 121069, Москва, ул. Малая Никитская, дом 31, стр. 1, эт.1, пом.4

«СОЛО-ТЕСТ Атлас»
Проточная

Кювета

СЕРИЯ ГОДЕН ДО ХРАНИТЬ
2WS205 11.22 от 2 до 8°C

«СОЛО-ТЕСТ Атлас»

Раствор PR2

СЕРИЯ

2WS205

ГОДЕН ДО

11.22

ХРАНИТЬ

от 2 до 8°C

500 мл

ООО «Онкодиагностика АТЛАС»

«СОЛО-ТЕСТ Атлас»

Раствор HT1

5 мл

СЕРИЯ ГОДЕН ДО ХРАНИТЬ
2WS205 11.22 -22 до -20°C

ООО «Онкодиагностика АТЛАС»

«СОЛО-ТЕСТ Атлас»

Картридж

35 мл

СЕРИЯ ГОДЕН ДО ХРАНИТЬ
2WS205 11.22 от -22 до -20°C

ООО «Онкодиагностика АТЛАС»

Макет маркировки для варианта исполнения «Соло-тест Атлас 48-а»

«СОЛО-ТЕСТ Атлас», вариант «Соло-тест Атлас 48-а»

Набор реагентов для одновременного выявления мутаций в генах BRAF, EGFR, KRAS, NRAS, KIT, PDGFRA в образцах опухолей методом высокопроизводительного секвенирования (Соло-тест Атлас) по ТУ 21.20.23-002-91709359-2018

Состав набора:

1) Комплект для целевого обогащения ДНК

2) Комплект для приготовления библиотек ДНК:

- Активатор 1 пробирка (96 мкл)
- Раствор Л 1 пробирка (192 мкл)
- ДНК-лигаза 1 пробирка (96 мкл)
- ЛС адаптеры 1 пробирка (96 мкл)
- Магнитные частицы 1 пробирка (3840 мкл)
- Реагент В 1 пробирка (4500 мкл)
- Реагент Е 1 пробирка (4500 мкл)
- ТЕ Буфер 2 пробирки (2 × 4500 мкл)
- ПЦР-смесь 2 2 пробирки (2 × 1152 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-1 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-2 1 пробирка (16 мкл)

- Олигонуклеотидные индексы Си-3 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-4 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-5 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-6 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-1 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-2 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-3 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-4 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-5 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-6 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-7 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-8 1 пробирка (12 мкл)



ООО «Онкодиагностика Атлас»: 121069, Москва, ул. Матвей Пинкиская, дом 31, стр. 1, эт. 1, пом. 1

СЕРИЯ

ГОДЕН ДО

2WS205

28.11.2022

-22°C



-20°C



№ РЗН 2021/13662 от 10.03.2021

«Сель-тест АТЛАС 48-3»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Состав комплекта:

Раствор праймеров 1 1 пробирка (240 мкл)

Раствор праймеров 2 1 пробирка (240 мкл)

ПЦР-смесь 1 1 пробирка (192 мкл)

ПКО 1 пробирка (24 мкл)

ОКО 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ

ГОД ЕН ДО

2W5285

28.11.2022

-22°C



-20°C



ООО «Биодиагностика АТЛАС» (ИП) Уфа, ул. Южная, дом 11, стр. 1, 100000

Макет маркировки для варианта исполнения «Соло-тест Атлас 48-б»

«СОЛО-ТЕСТ Атлас», вариант «Соло-тест Атлас 48-Б»

Набор реагентов для одновременного выявления мутаций в генах BRAF, EGFR, KRAS, NRAS, KIT, PDGFRA в образцах опухолей методом высокопроизводительного секвенирования (Соло-тест Атлас) по ТУ 21.20.23-002-91709359-2018

Состав набора:

1) Комплект для целевого обогащения ДНК

2) Комплект для приготовления библиотек ДНК:

- Активатор 1 пробирка (96 мкл)
- Раствор Л 1 пробирка (192 мкл)
- ДНК-лигаза 1 пробирка (96 мкл)
- ЛС адаптеры 1 пробирка (96 мкл)
- Магнитные частицы 1 пробирка (3840 мкл)
- Реагент В 1 пробирка (4500 мкл)
- Реагент Е 1 пробирка (4500 мкл)
- ТЕ Буфер 2 пробирки (2 x 4500 мкл)
- ПЦР-смесь 2 2 пробирки (2 x 1152 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-7 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-8 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-9 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-10 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-11 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Си-12 1 пробирка (16 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-1 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-2 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-3 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-4 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-5 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-6 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-7 1 пробирка (12 мкл)
- Олигонуклеотидные индексы Ли-8 1 пробирка (12 мкл)




ООО «Биодиагностика Атлас» (СПО), Москва, ст. Митин Промышлен
д.ч. 12 стр. 1, т. 7, 10-04

СЕРИЯ

2WS205

ГОДЕН ДО

28.11.2022



-22°C

-20°C



№ РЗН 2021/13662 от 10.03.2021

«Соло-тест Атлас 48-6»

Комплект для целевого обогащения ДНК

Состав комплекта:

Раствор праймеров 1 1 пробирка (240 мкл)

Раствор праймеров 2 1 пробирка (240 мкл)

ПЦР-смесь 1 1 пробирка (192 мкл)

ПКО 1 пробирка (24 мкл)

ОКО 1 пробирка (24 мкл)

СЕРИЯ

ГОДЕН ДО

2WS205

28.11.2022

-22°C



-20°C



ООО «ОНИКОТЕСТ» АТЛАС, г. г. Москва, Метро Промышленность стр. 1, 1 этаж



Всего листов 25