

Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический
завод им. Э.С. Яламова»



УВЛАЖНИТЕЛЬ ДЫХАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

ТЕВЛАР-«УОМЗ»

по АМНК.941629.001ТУ

(ТУ 32.50.21-121-07539541-2018)

Фотографические изображения медицинского изделия

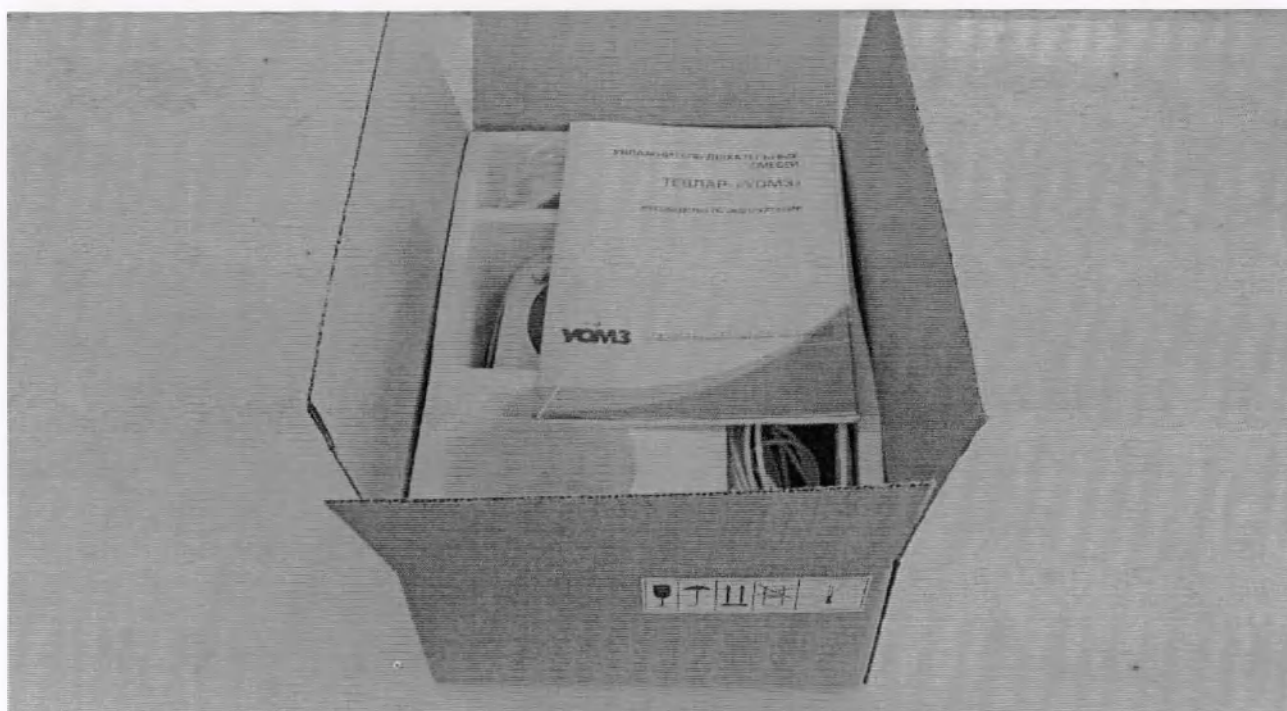


Рисунок 1 – Упаковка увлажнителя



Рисунок 2 – Блок управления 3703.01100000

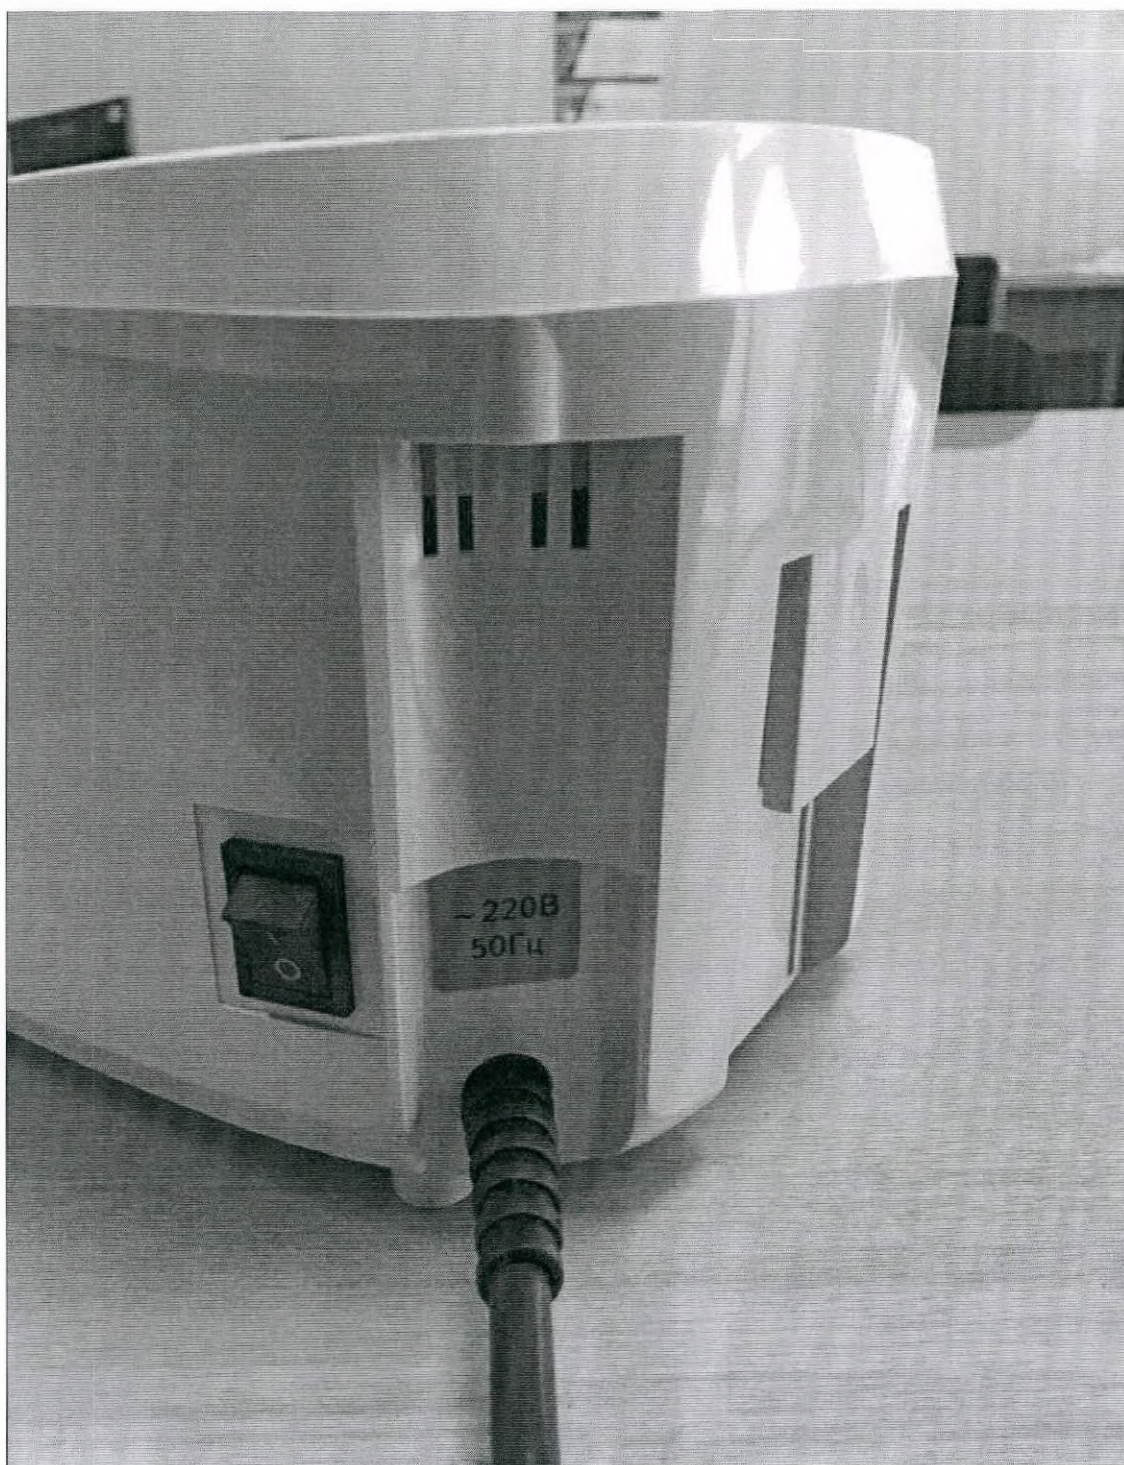


Рисунок 3 – Блок управления 3703.01100000, маркировка

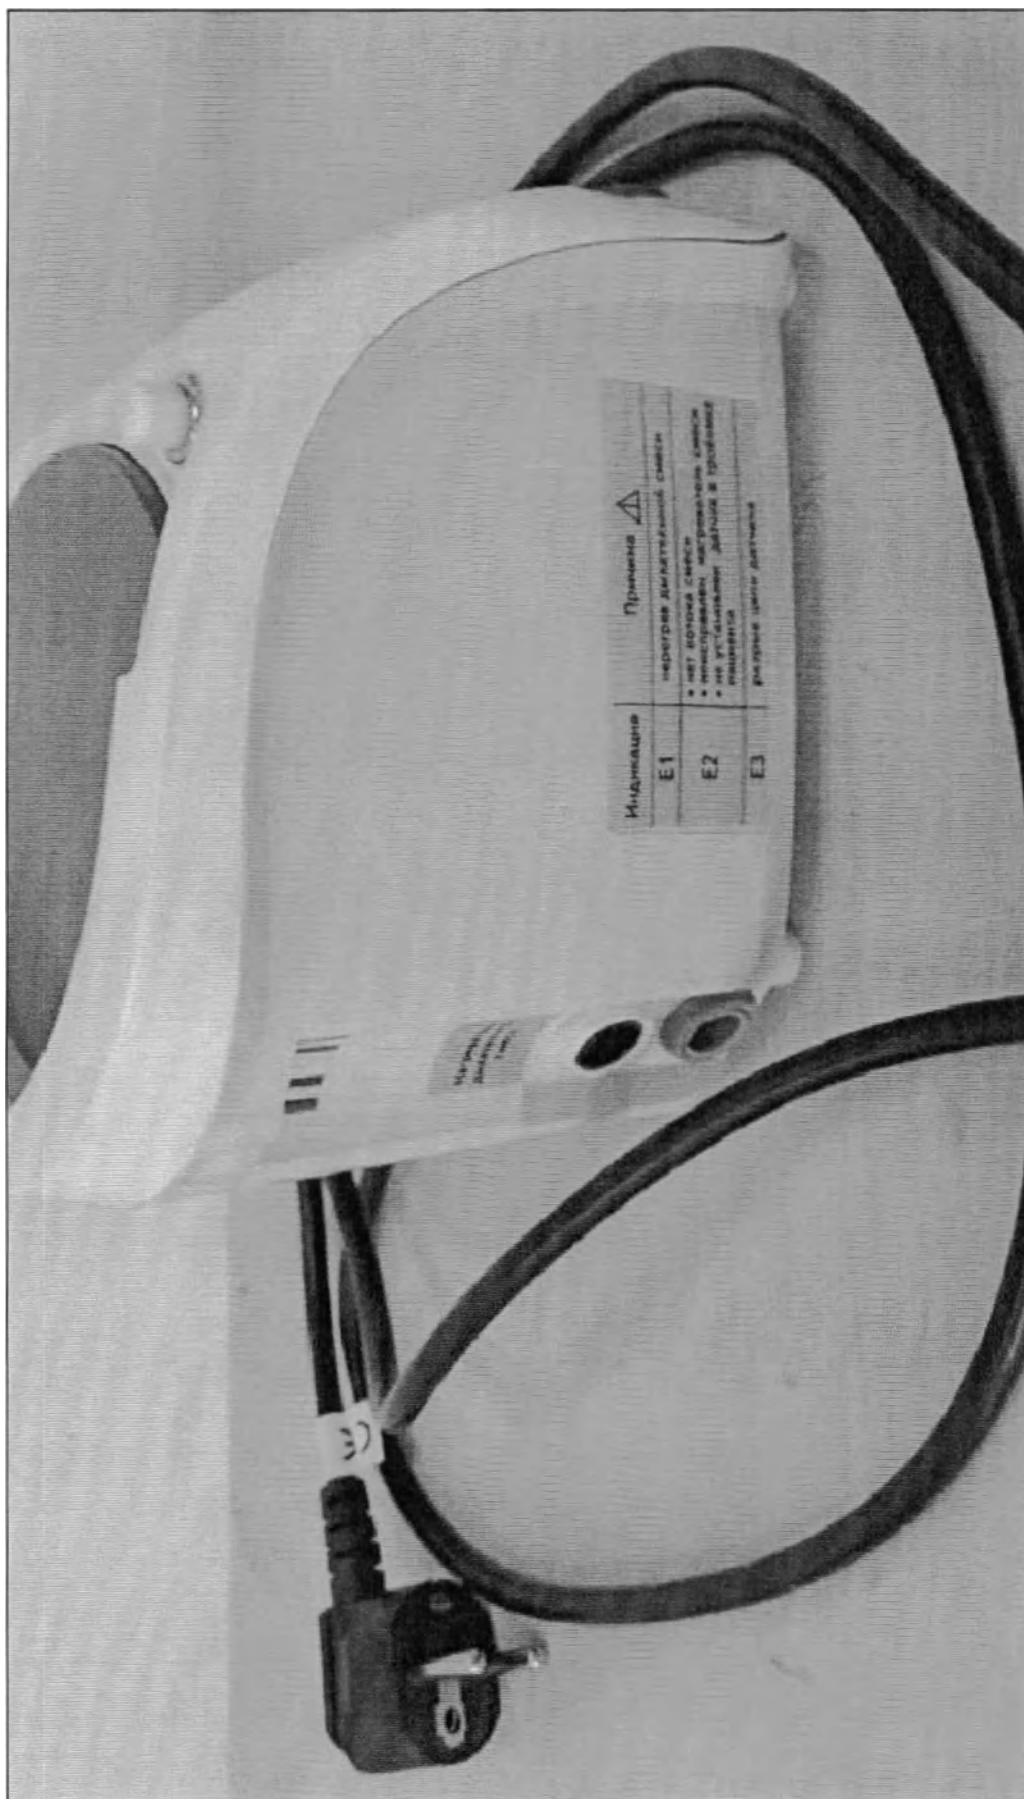


Рисунок 4 – Блок управления 3703.01100000, маркировка

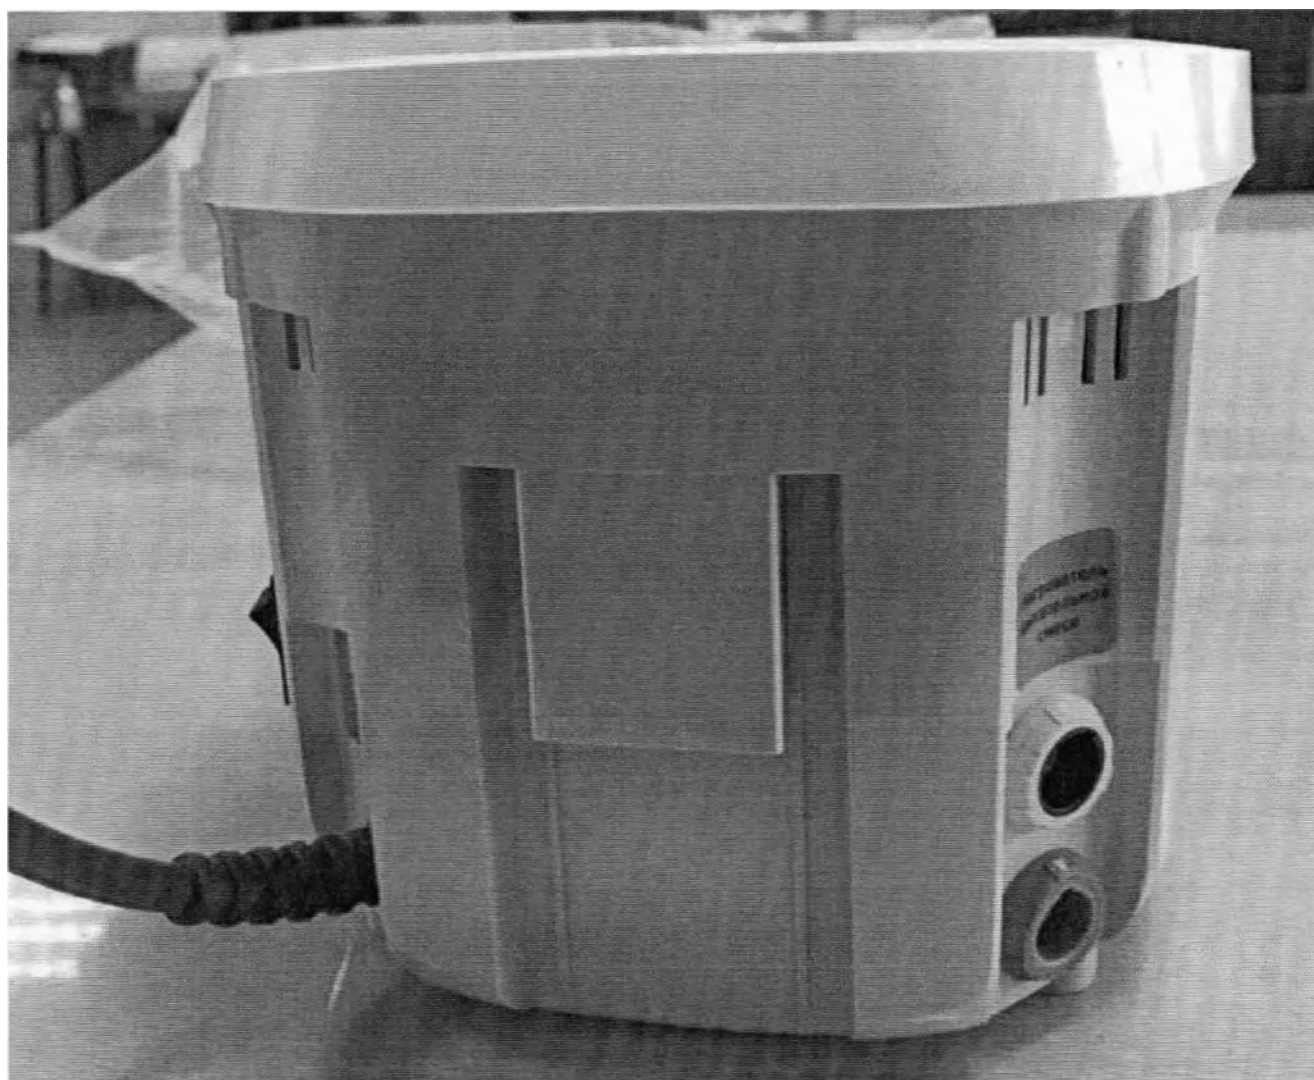


Рисунок 5 – Блок управления 3703.01100000, вид сзади

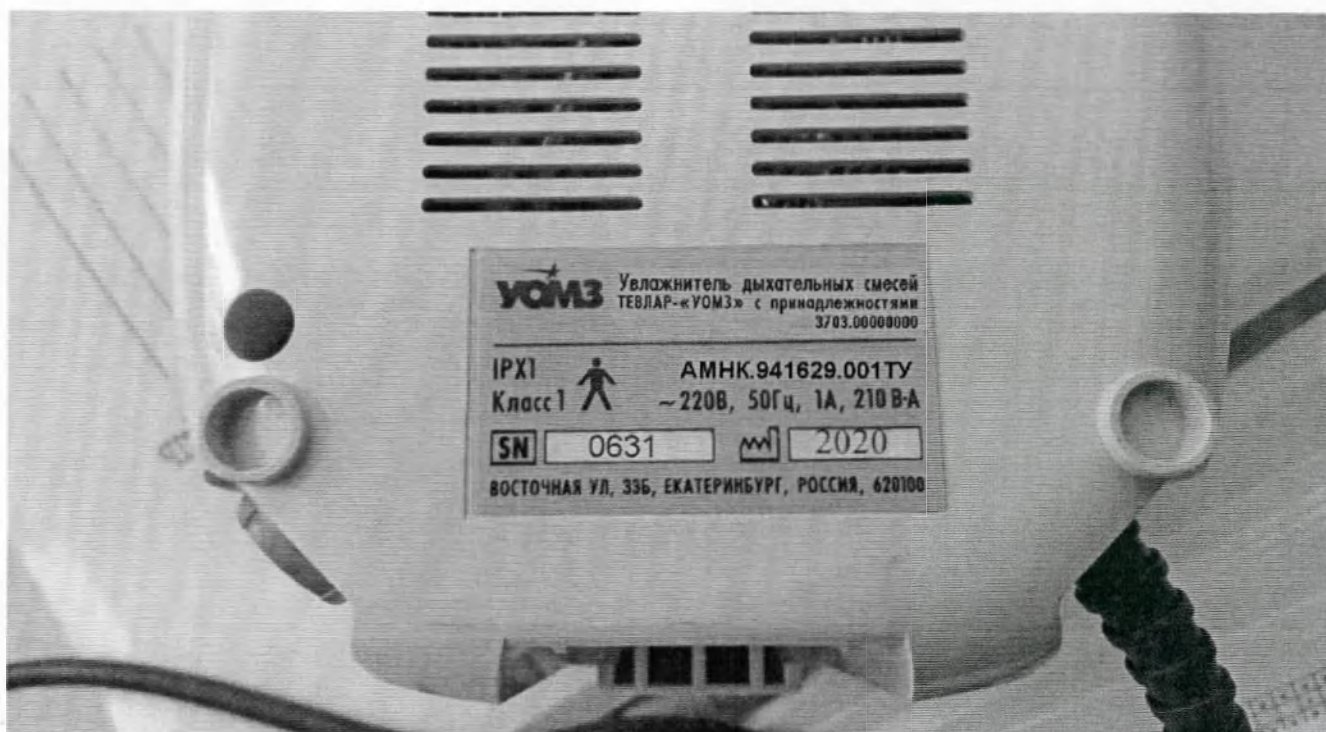


Рисунок 6 – Блок управления 3703.01100000, маркировка



Рисунок 7 – Блок управления 3703.01100000-01



Рисунок 8 – Блок управления 3703.01100000-01, маркировка

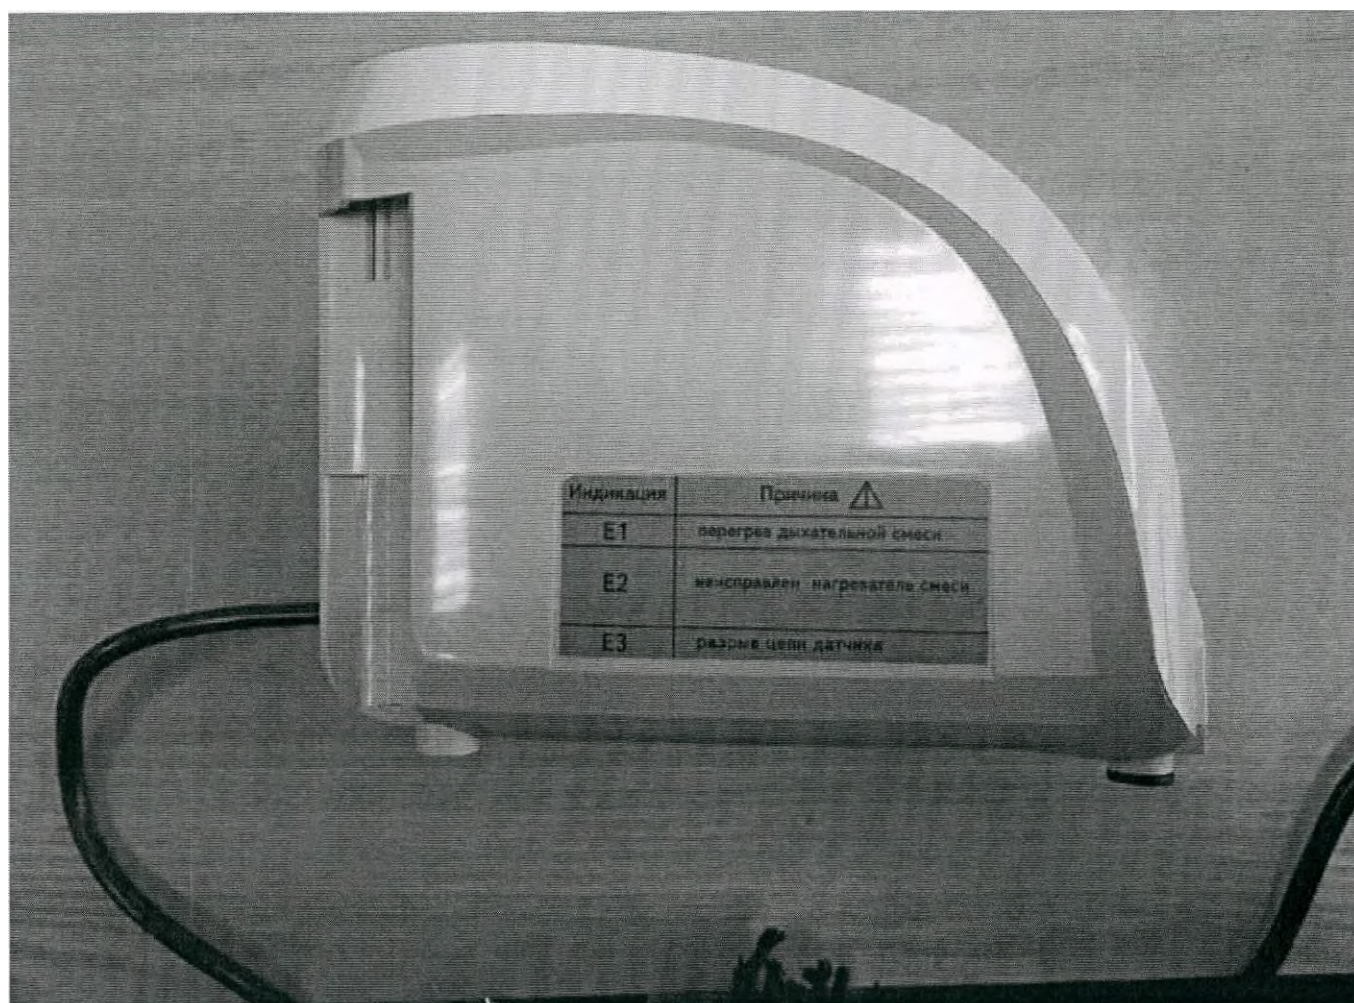


Рисунок 9 – Блок управления 3703.01100000-01, маркировка

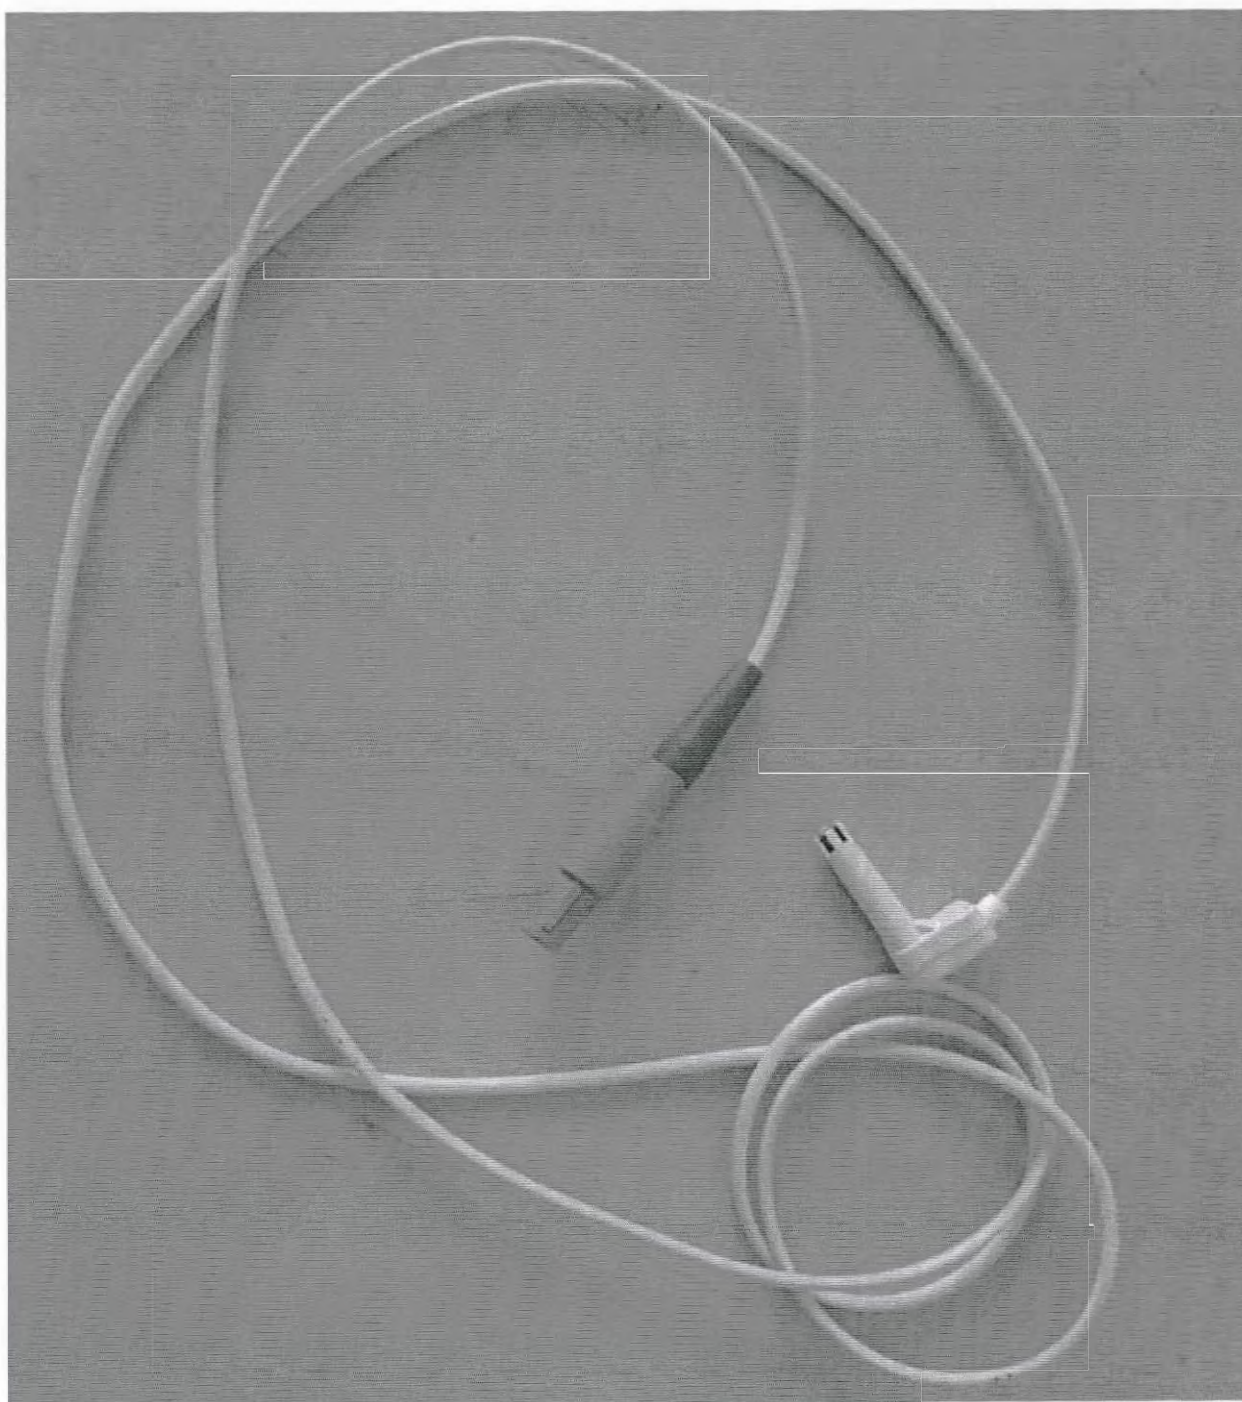


Рисунок 10 – Датчик температуры / влажности 3703.41000000

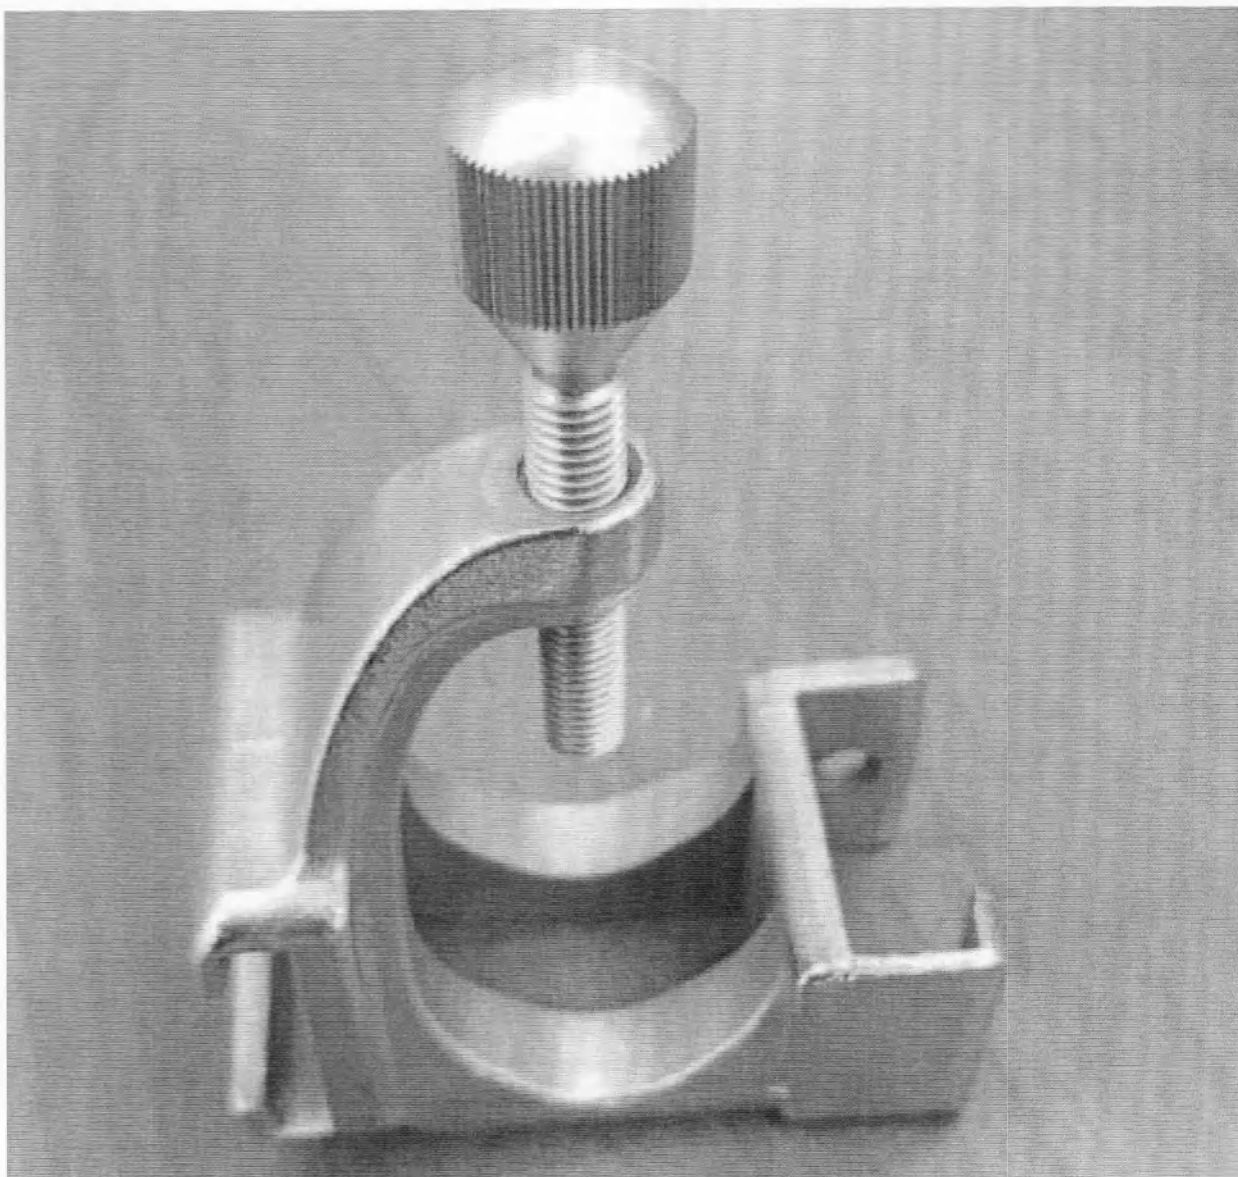


Рисунок 11 – Кронштейн 3150.17000000

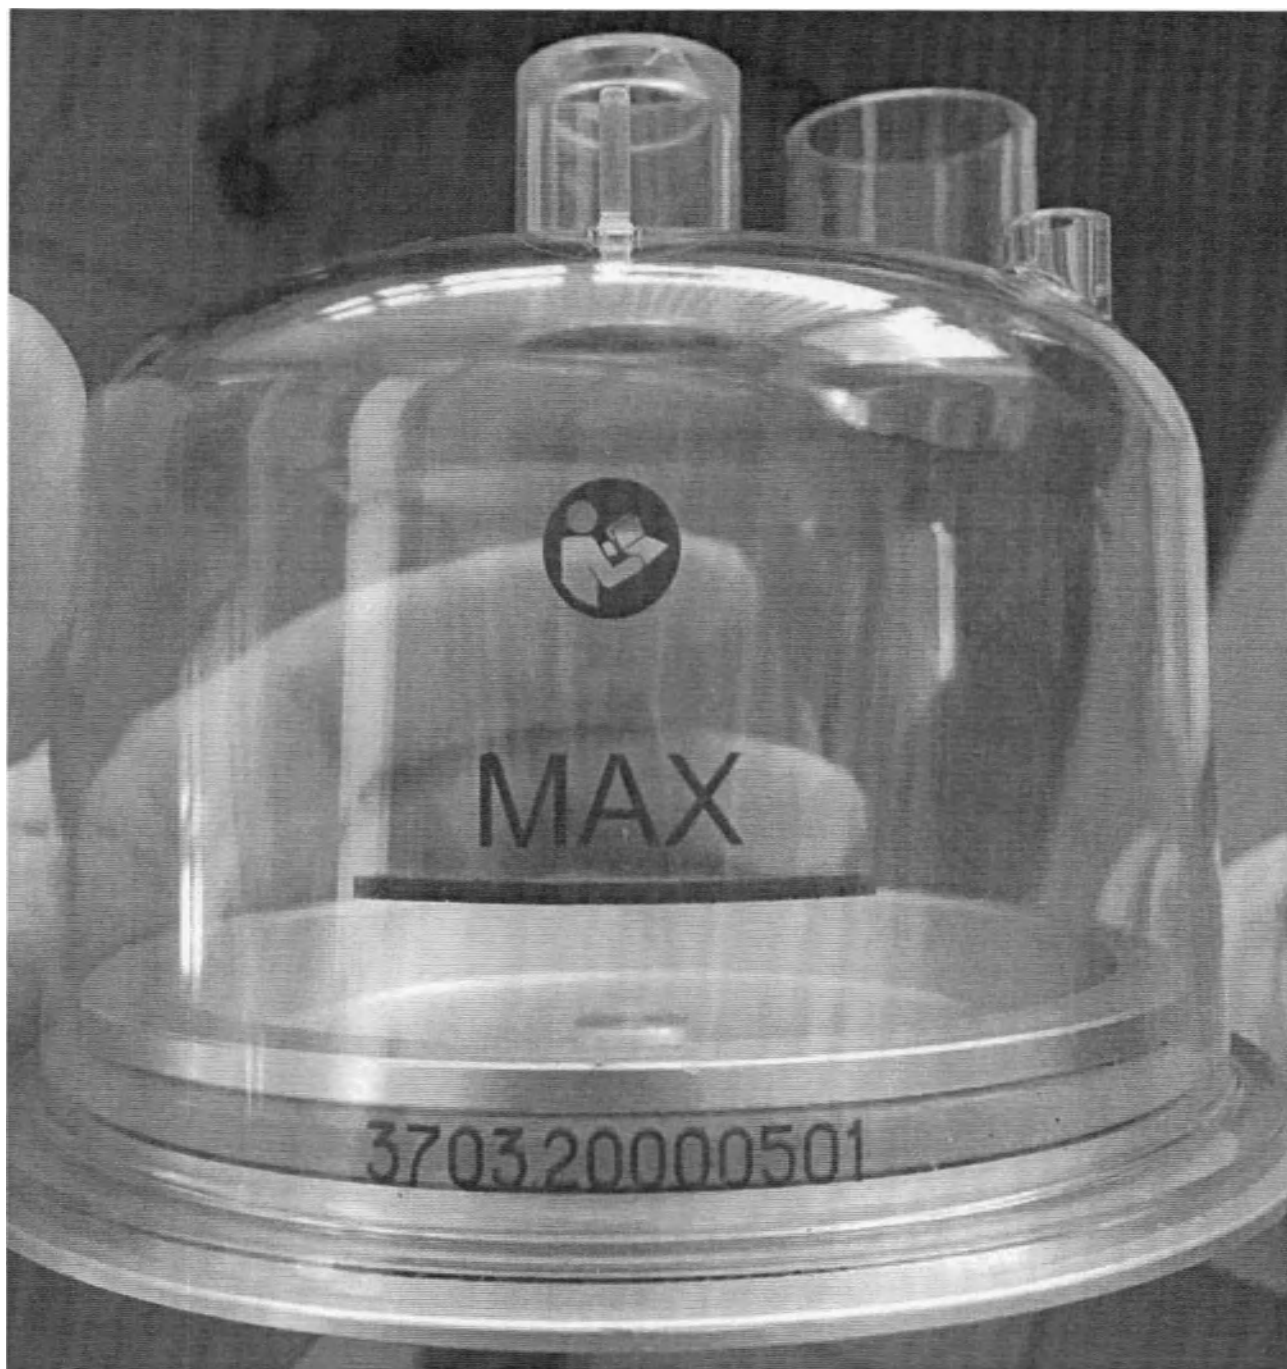


Рисунок 12 – Камера увлажнителя многоразовая 3703.20000501



Рисунок 13 – Адаптер нагревательного провода для дыхательных контуров с обогревом линии вдоха 3703.02000000.



Рисунок 14 – Адаптер нагревательного провода для дыхательных контуров с двойным обогревом 3703.02100000.



Рисунок 15 – Термометр 3703.01500000-01



Рисунок 16 - изображение маркировки Увлажнитель дыхательных смесей ТЕВЛАР - «УОМЗ» по АМНК.941629.001ТУ (ТУ 32.50.21-121-07539541-2018), вариант исполнения 3703.00000000


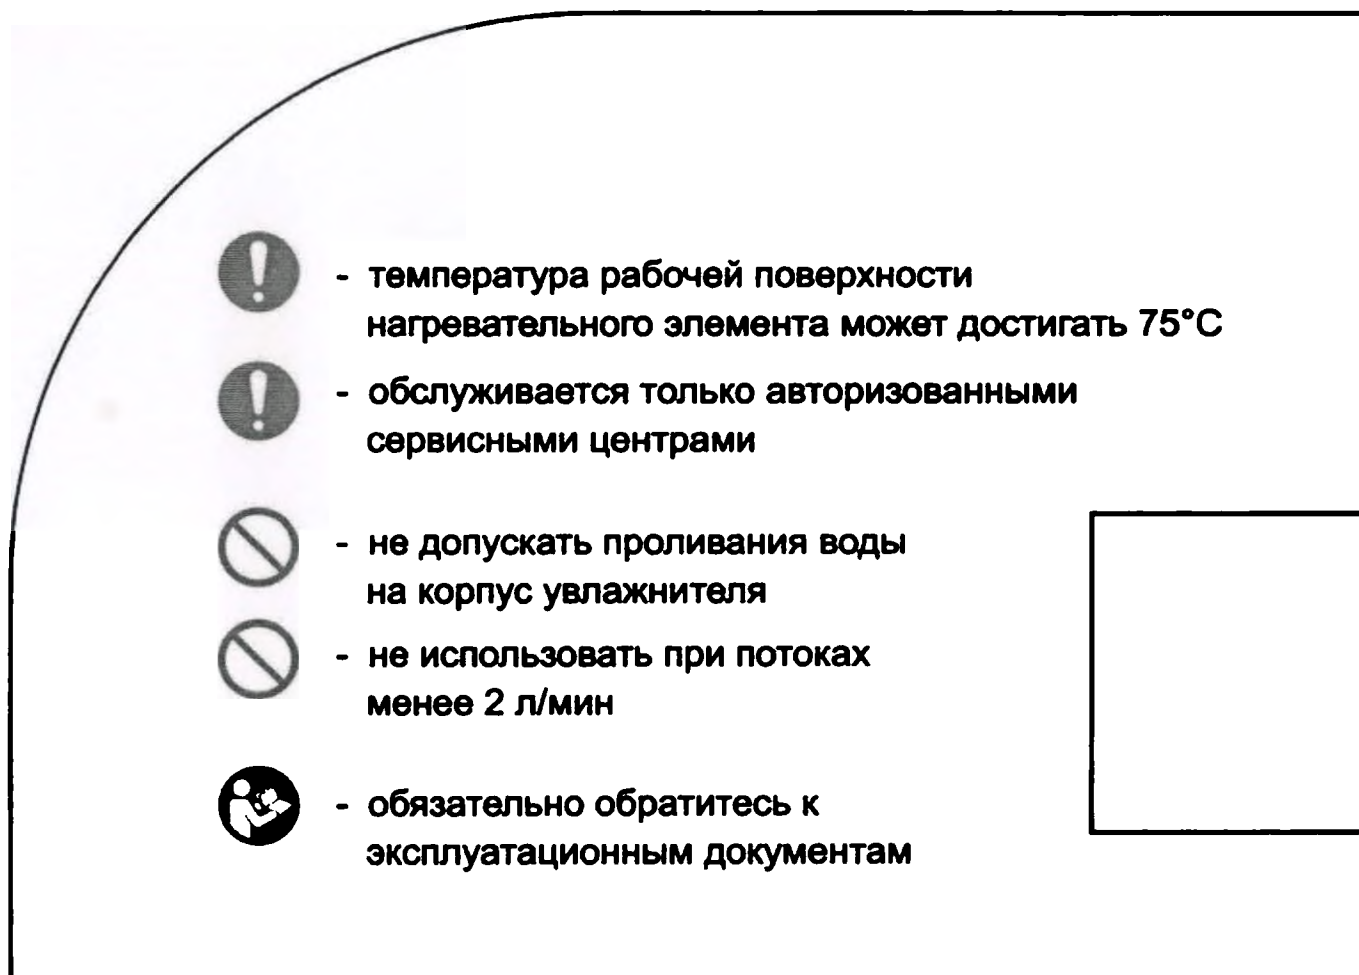


Рисунок 17 - изображение маркировки Увлажнитель дыхательных смесей ТЕВЛАР - «УОМЗ» по АМНК.941629.001ТУ (ТУ 32.50.21-121-07539541-2018), вариант исполнения 3703.00000000-

01

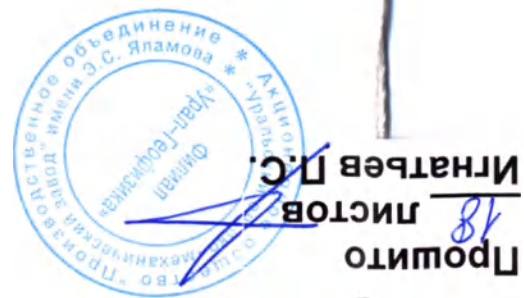

18
Пройто
листов