

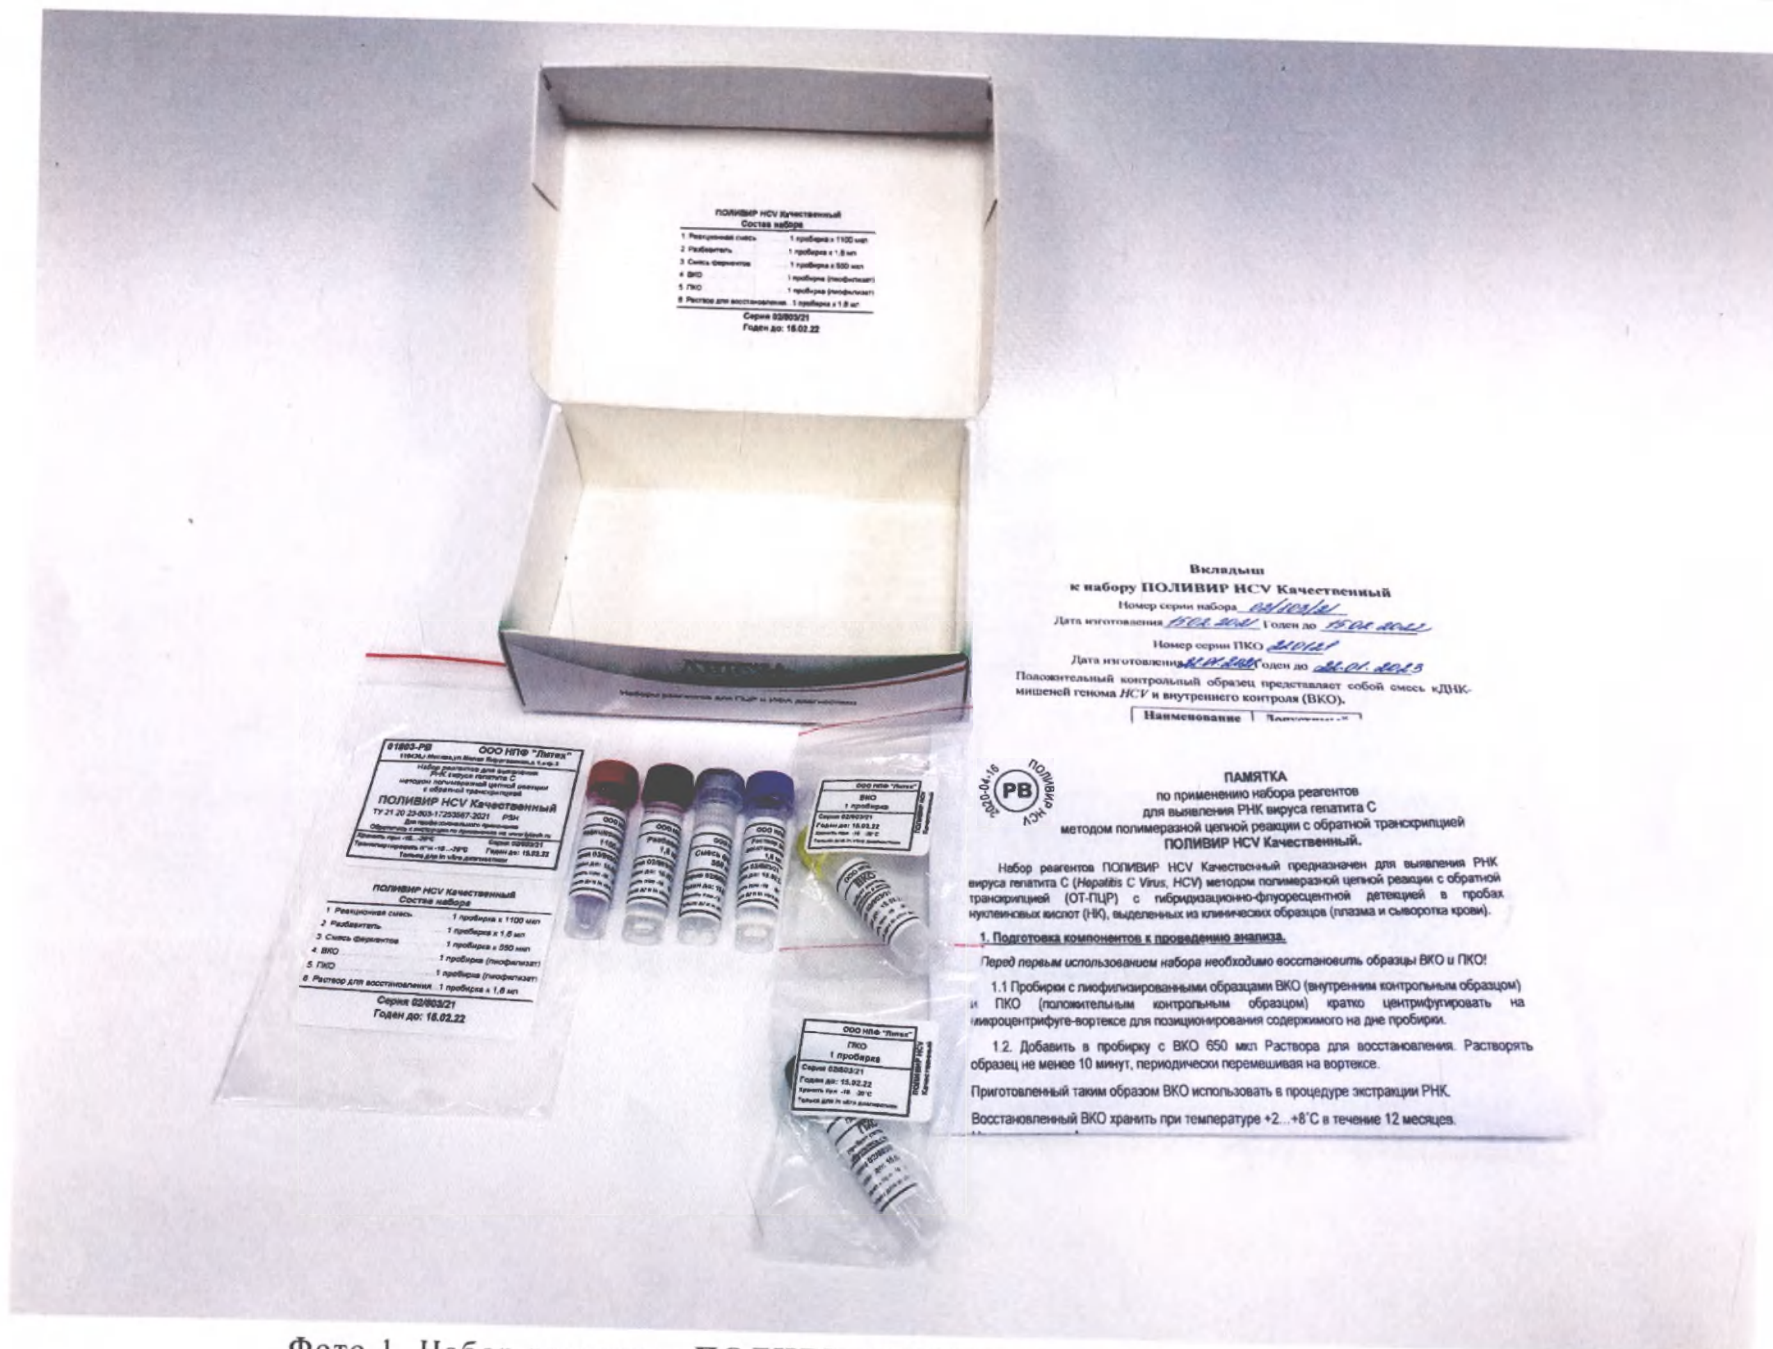


Фото 1. Набор реагентов ПОЛИВИР HCV Качественный. Состав набора.



Фото 2. Набор реагентов ПОЛИВИР HCV Качественный. Потребительская упаковка.

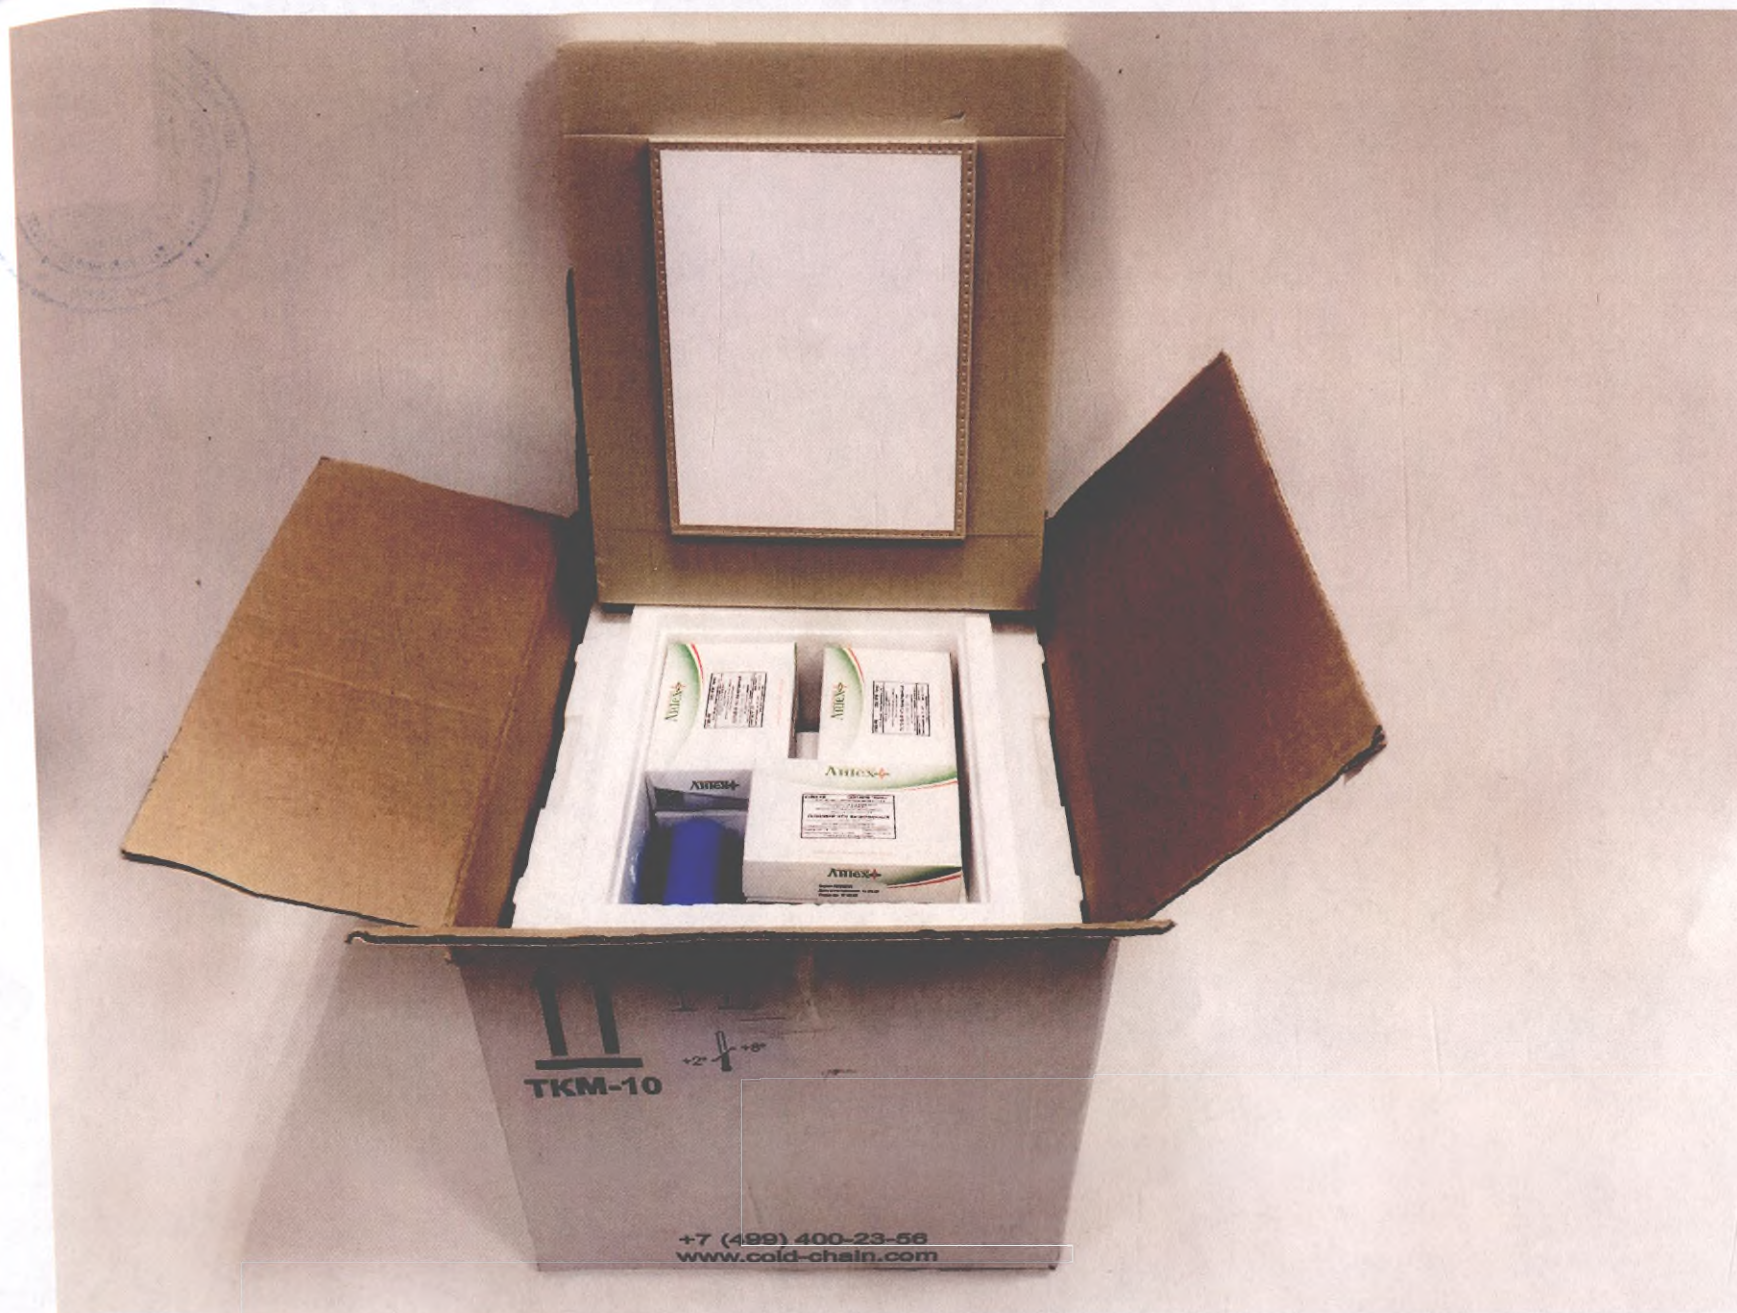


Фото 3. Набор реагентов ПОЛИВИР HCV Качественный. Групповая упаковка.

Прошито, проверено,
скреплено печатью.

Количество листов
шт.

И. директор

Наумов А.Ю.



ПОЛИВИР HCV Качественный
Состав набора

1. Реакционный состав	1 пробирка x 1100 мкл
2. Растворитель	1 пробирка x 1,8 мл
3. Смесь ферментов	1 пробирка x 500 мкл
4. ВКО	1 пробирка (индивидуально)
5. РНД	1 пробирка (индивидуально)
6. Раствор для восстановления	1 пробирка x 1,8 мл

Серия 0280921
Годен до: 16.02.22

Вкладыш
к набору ПОЛИВИР HCV Качественный

Номер серии набора 0280921
Дата изготовления 15.02.2021 Годен до 16.02.2022

Номер серии ПКО 0280921
Дата изготовления 15.02.2021 Годен до 16.02.2022

Положительный контрольный образец представляет собой смесь клонированного генома HCV и внутреннего контроля (ВКО).

Наименование	Положительный контрольный образец
--------------	-----------------------------------

ПАМЯТКА
по применению набора реагентов
для выявления РНК вируса гепатита С
методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией
ПОЛИВИР HCV Качественный.

Набор реагентов ПОЛИВИР HCV Качественный предназначен для выявления РНК вируса гепатита С (Hepatitis C Virus, HCV) методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) с гибридоизотопно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот (НҚ), выделенных из клеточных образцов (плазма и сыворотка крови).

1. Подготовка компонентов к проведению анализа.

Перед первым использованием набора необходимо восстановить образцы ВКО и ПКО!

1.1 Пробирки с лиофилизированными образцами ВКО (внутренним контрольным образцом) и ПКО (положительным контрольным образцом) кратко центрифугировать на микроцентрифуге-вortexe для позиционирования содержимого на дне пробирки.

1.2. Добавить в пробирку с ВКО 650 мкл Раствора для восстановления. Растворить образец не менее 10 минут, периодически перемешивая на vortexe.

Приготовленный таким образом ВКО использовать в процедуре экстракции РНК.

Восстановленный ВКО хранить при температуре +2...+8°C в течение 12 месяцев.

ПОЛИВИР HCV Качественный
Состав набора

1. Реакционный состав	1 пробирка x 1100 мкл
2. Растворитель	1 пробирка x 1,8 мл
3. Смесь ферментов	1 пробирка x 500 мкл
4. ВКО	1 пробирка (индивидуально)
5. РНД	1 пробирка (индивидуально)
6. Раствор для восстановления	1 пробирка x 1,8 мл

Серия 0280921
Годен до: 16.02.22



ВКО
1 пробирка

Серия 0280921
Годен до: 16.02.22
Гарантия: 12 мес.



Фото 2. Набор реагентов ПОЛИВИР HCV Качественный. Потребительская упаковка.

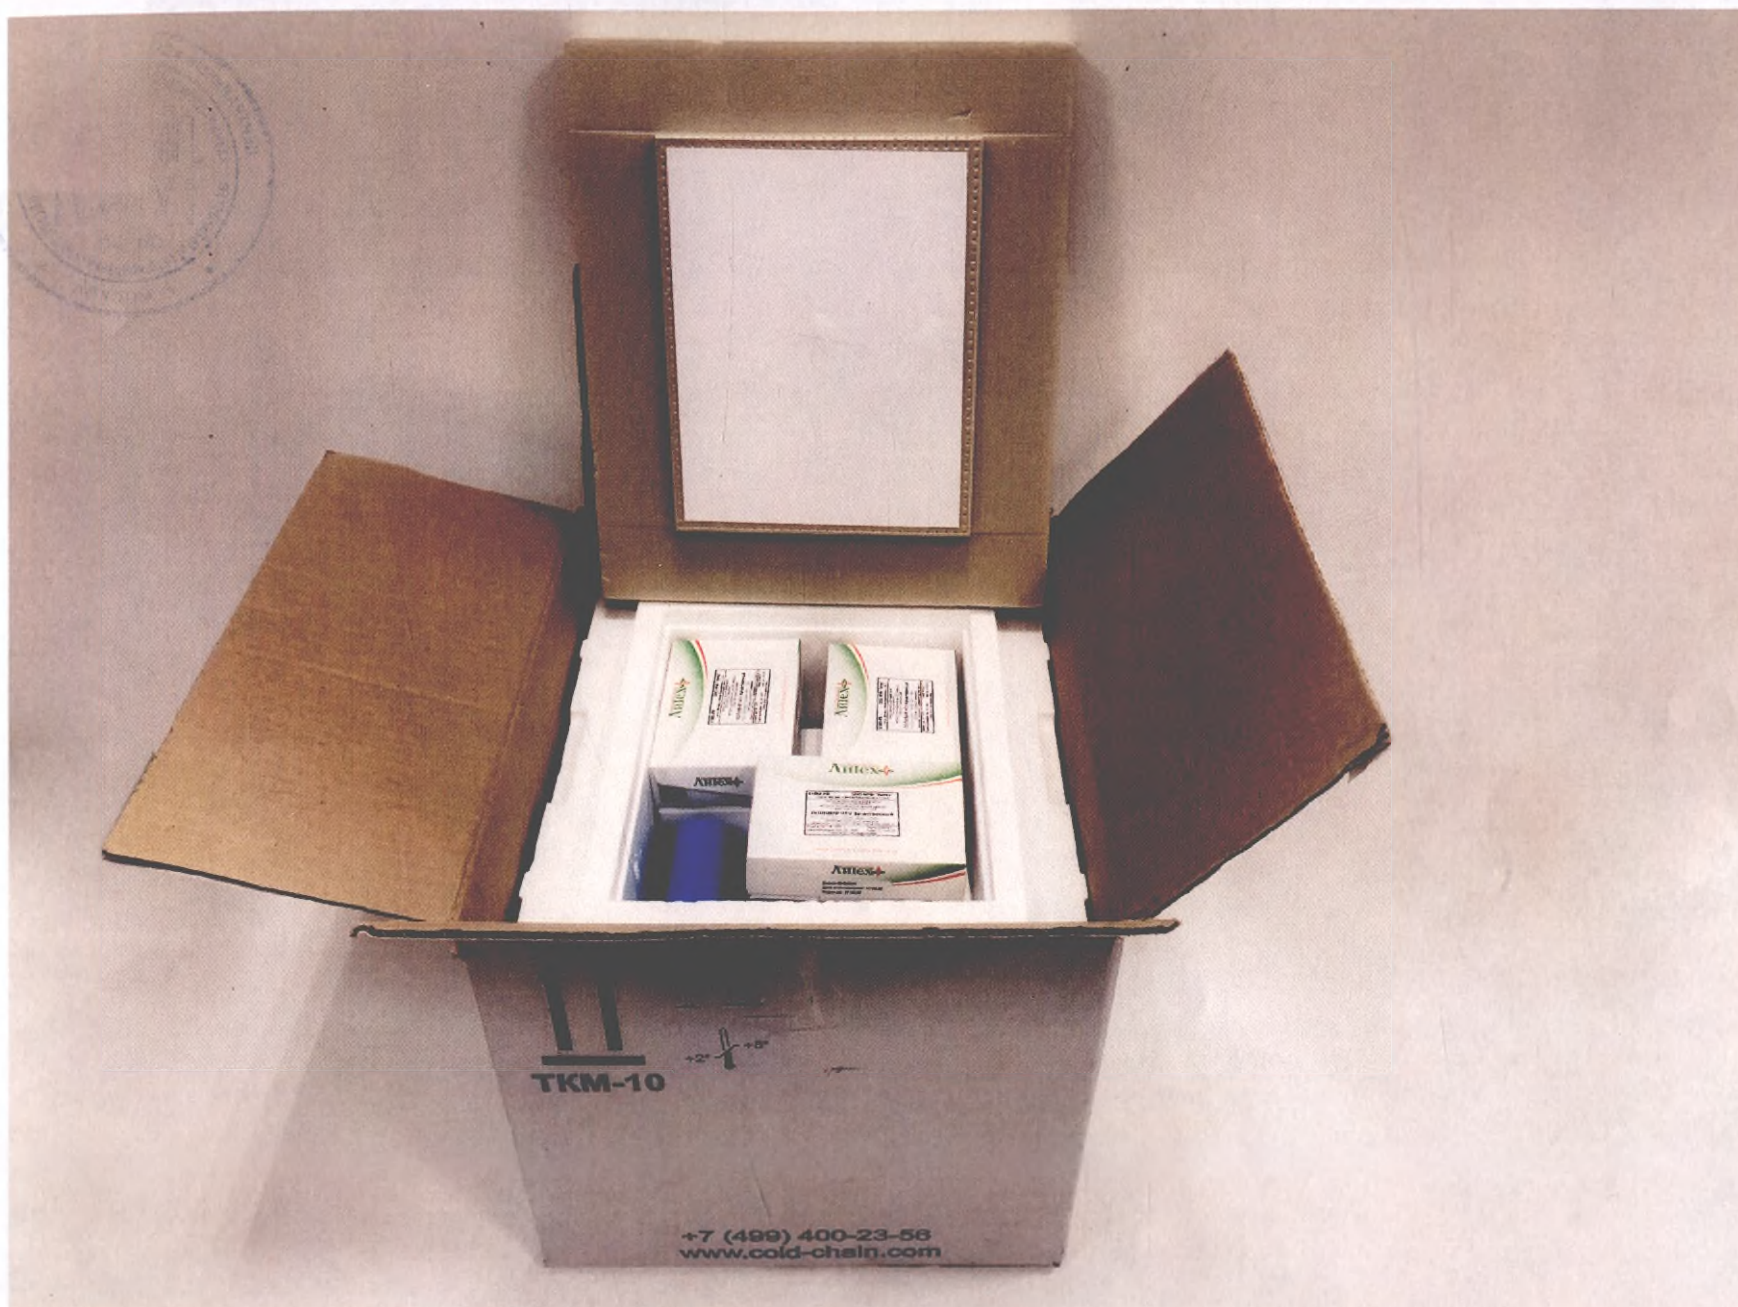


Фото 3. Набор реагентов ПОЛИВИР HCV Качественный. Групповая упаковка.

прешито, проверено,
скреплено печатью.

Количество листов

шт.

Директор

Наумов А.Ю.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО НПФ «Литех»

А.Ю. Наумов

20 г.



ООО НПФ «Литех»

Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией **ПОЛИВИР HCV Качественный**

ТУ 21.20.23-803-17253567-2021

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

01803-РВ		ООО НПФ "Литех"	
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 3			
Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией			
ПОЛИВИР HCV Качественный			
ТУ 21.20.23-803-17253567-2021 РЗН			
Для профессионального применения			
Обратитесь к инструкции по применению на www.lytech.ru			
Хранить при -18...-20°C		Серия 02/803/21	
Транспортировать при -18...-20°C		Годен до: 15.02.22	
Только для in vitro диагностики			

ПОЛИВИР HCV Качественный Состав набора

1 Реакционная смесь	1 пробирка x 1100 мкл
2 Разбавитель	1 пробирка x 1.8 мл
3 Смесь ферментов	1 пробирка x 550 мкл
4 ВКО	1 пробирка (лиофилизат)
5 ПКО	1 пробирка (лиофилизат)
6 Раствор для восстановления	1 пробирка x 1.8 мл

Серия 02/803/21

Годен до: 15.02.22

Серия 02/803/21

Дата изготовления: 15.02.21

Годен до: 15.02.22

Маркировка внутренней упаковки

01803-РВ		ООО НПФ "Литех"	
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 3			
Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией			
ПОЛИВИР HCV Качественный			
ТУ 21.20.23-803-17253567-2021 РЗН			
Для профессионального применения			
Обратитесь к инструкции по применению на www.lytech.ru			
Хранить при -18...-20°C		Серия 02/803/21	
Транспортировать при -18...-20°C		Годен до: 15.02.22	
Только для in vitro диагностики			

ПОЛИВИР HCV Качественный Состав набора

1 Реакционная смесь	1 пробирка x 1100 мкл
2 Разбавитель	1 пробирка x 1.8 мл
3 Смесь ферментов	1 пробирка x 550 мкл
4 ВКО	1 пробирка (лиофилизат)
5 ПКО	1 пробирка (лиофилизат)
6 Раствор для восстановления	1 пробирка x 1.8 мл

Серия 02/803/21

Годен до: 15.02.22

ООО НПФ "Литех"
ВКО
1 пробирка
Серия 02/803/21
Годен до: 15.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
ПКО
1 пробирка
Серия 02/803/21
Годен до: 15.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"
Реакционная смесь
1100 мкл
Серия 02/803/21
Годен до: 15.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
Разбавитель
1.8 мл
Серия 02/803/21
Годен до: 15.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
Смесь ферментов
550 мкл
Серия 02/803/21
Годен до: 15.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
ВКО
(требует восстановления)
(обратитесь к инструкции)
Серия 02/803/21
Годен до: 15.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
ПКО
(требует восстановления)
(обратитесь к инструкции)
Серия 02/803/21
Годен до: 15.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
Раствор для восстановления
1.8 мл
Серия 02/803/21
Годен до: 15.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

Образец маркировки групповой упаковки

Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С
методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией
ПОЛИВИР HCV Качественный

Номер серии 02/803/21

Дата изготовления 15.02.21

Годен до 15.02.22

Число единиц потребительской упаковки _____

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____

Условия хранения:

ПОЛИВИР HCV Качественный должен храниться при температуре
-18...-20°C в течение всего срока годности. Срок годности набора – 12 месяцев.

Условия транспортировки:

рекомендуется транспортировать при температуре хранения. Допустима
транспортировка при температуре +2°...+8°C в течение трех дней (не более).

Копия на 2 листах верна.



Директор ООО НПФ «Литех»

Наумов А.Ю.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО НПФ «Литех»

А.Ю. Наумов

20 г.



ООО НПФ «Литех»

Набор реагентов для выявления РНК вируса
гепатита С методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией
ПОЛИВИР HCV Качественный

ТУ 21.20.23-803-17253567-2021

Маркировка набора реагентов

Внешняя сторона упаковки

Внутренняя сторона упаковки

Заклейка

01803-РВ	ООО НПФ "Литех"
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 3	
Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией	
ПОЛИВИР HCV Качественный	
ТУ 21.20.23-803-17253567-2021 РЗН	
Для профессионального применения	
Обратиться к инструкции по применению на www.lytech.ru	
Хранить при -18...-20°C	Серия 02/803/21
Транспортировать при -18...-20°C	Годен до: 15.02.22
Только для in vitro диагностики	

ПОЛИВИР HCV Качественный	
Состав набора	
1 Реакционная смесь	1 пробирка x 1100 мкл
2 Разбавитель	1 пробирка x 1,8 мл
3 Смесь ферментов	1 пробирка x 550 мкл
4 ВКО	1 пробирка (лиофилизат)
5 ПКО	1 пробирка (лиофилизат)
6 Раствор для восстановления	1 пробирка x 1,8 мл
Серия 02/803/21	
Годен до: 15.02.22	

Серия 02/803/21
Дата изготовления: 15.02.21
Годен до: 15.02.22

Маркировка внутренней упаковки

01803-РВ	ООО НПФ "Литех"
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 3	
Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией	
ПОЛИВИР HCV Качественный	
ТУ 21.20.23-803-17253567-2021 РЗН	
Для профессионального применения	
Обратиться к инструкции по применению на www.lytech.ru	
Хранить при -18...-20°C	Серия 02/803/21
Транспортировать при -18...-20°C	Годен до: 15.02.22
Только для in vitro диагностики	

ПОЛИВИР HCV Качественный	
Состав набора	
1 Реакционная смесь	1 пробирка x 1100 мкл
2 Разбавитель	1 пробирка x 1,8 мл
3 Смесь ферментов	1 пробирка x 550 мкл
4 ВКО	1 пробирка (лиофилизат)
5 ПКО	1 пробирка (лиофилизат)
6 Раствор для восстановления	1 пробирка x 1,8 мл
Серия 02/803/21	
Годен до: 15.02.22	

ООО НПФ "Литех"
ВКО
1 пробирка
Серия 02/803/21
Годен до: 15.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
ПКО
1 пробирка
Серия 02/803/21
Годен до: 15.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"
Реакционная смесь
1100 мкл
Серия 02/803/21
Годен до: 15.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
Разбавитель
1,8 мл
Серия 02/803/21
Годен до: 15.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
Смесь ферментов
550 мкл
Серия 02/803/21
Годен до: 15.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
ВКО
(требует растворения)
(обратиться к инструкции)
Серия 02/803/21
Годен до: 15.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
ПКО
(требует растворения)
(обратиться к инструкции)
Серия 02/803/21
Годен до: 15.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех"
Раствор для восстановления
1,8 мл
Серия 02/803/21
Годен до: 15.02.22
Хранить при -18...-20°C
Только для in vitro диагностики

Образец маркировки групповой упаковки

Набор реагентов для выявления РНК вируса гепатита С
методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией
ПОЛИВИР HCV Качественный

Номер серии 02/803/21

Дата изготовления 15.02.21

Гожен до 15.02.22

Число единиц потребительской упаковки _____

Масса нетто _____

Масса брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____

Условия хранения:

ПОЛИВИР HCV Качественный должен храниться при температуре
-18...-20°C в течение всего срока годности. Срок годности набора – 12 месяцев.

Условия транспортировки:

рекомендуется транспортировать при температуре хранения. Допустима
транспортировка при температуре +2°...+8°C в течение трех дней (не более).

Копия на 2 листах верна.



Директор ООО НПФ «Литех»

Наумов А.Ю.