

«УТВЕРЖДАЮ»

Супервайзер по регистрации

ООО «Джонсон & Джонсон»

Е. Паламарь

2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия

Аппарат сшивающе-режущий с изменяющимся углом рабочей части,
эндоскопический, электрический, автономный, в вариантах исполнения



Рис. 1. Внешний вид медицинского изделия. Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 60 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, вариант исполнения: ECHELON Flex Plus 60, длина ствола 280 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.


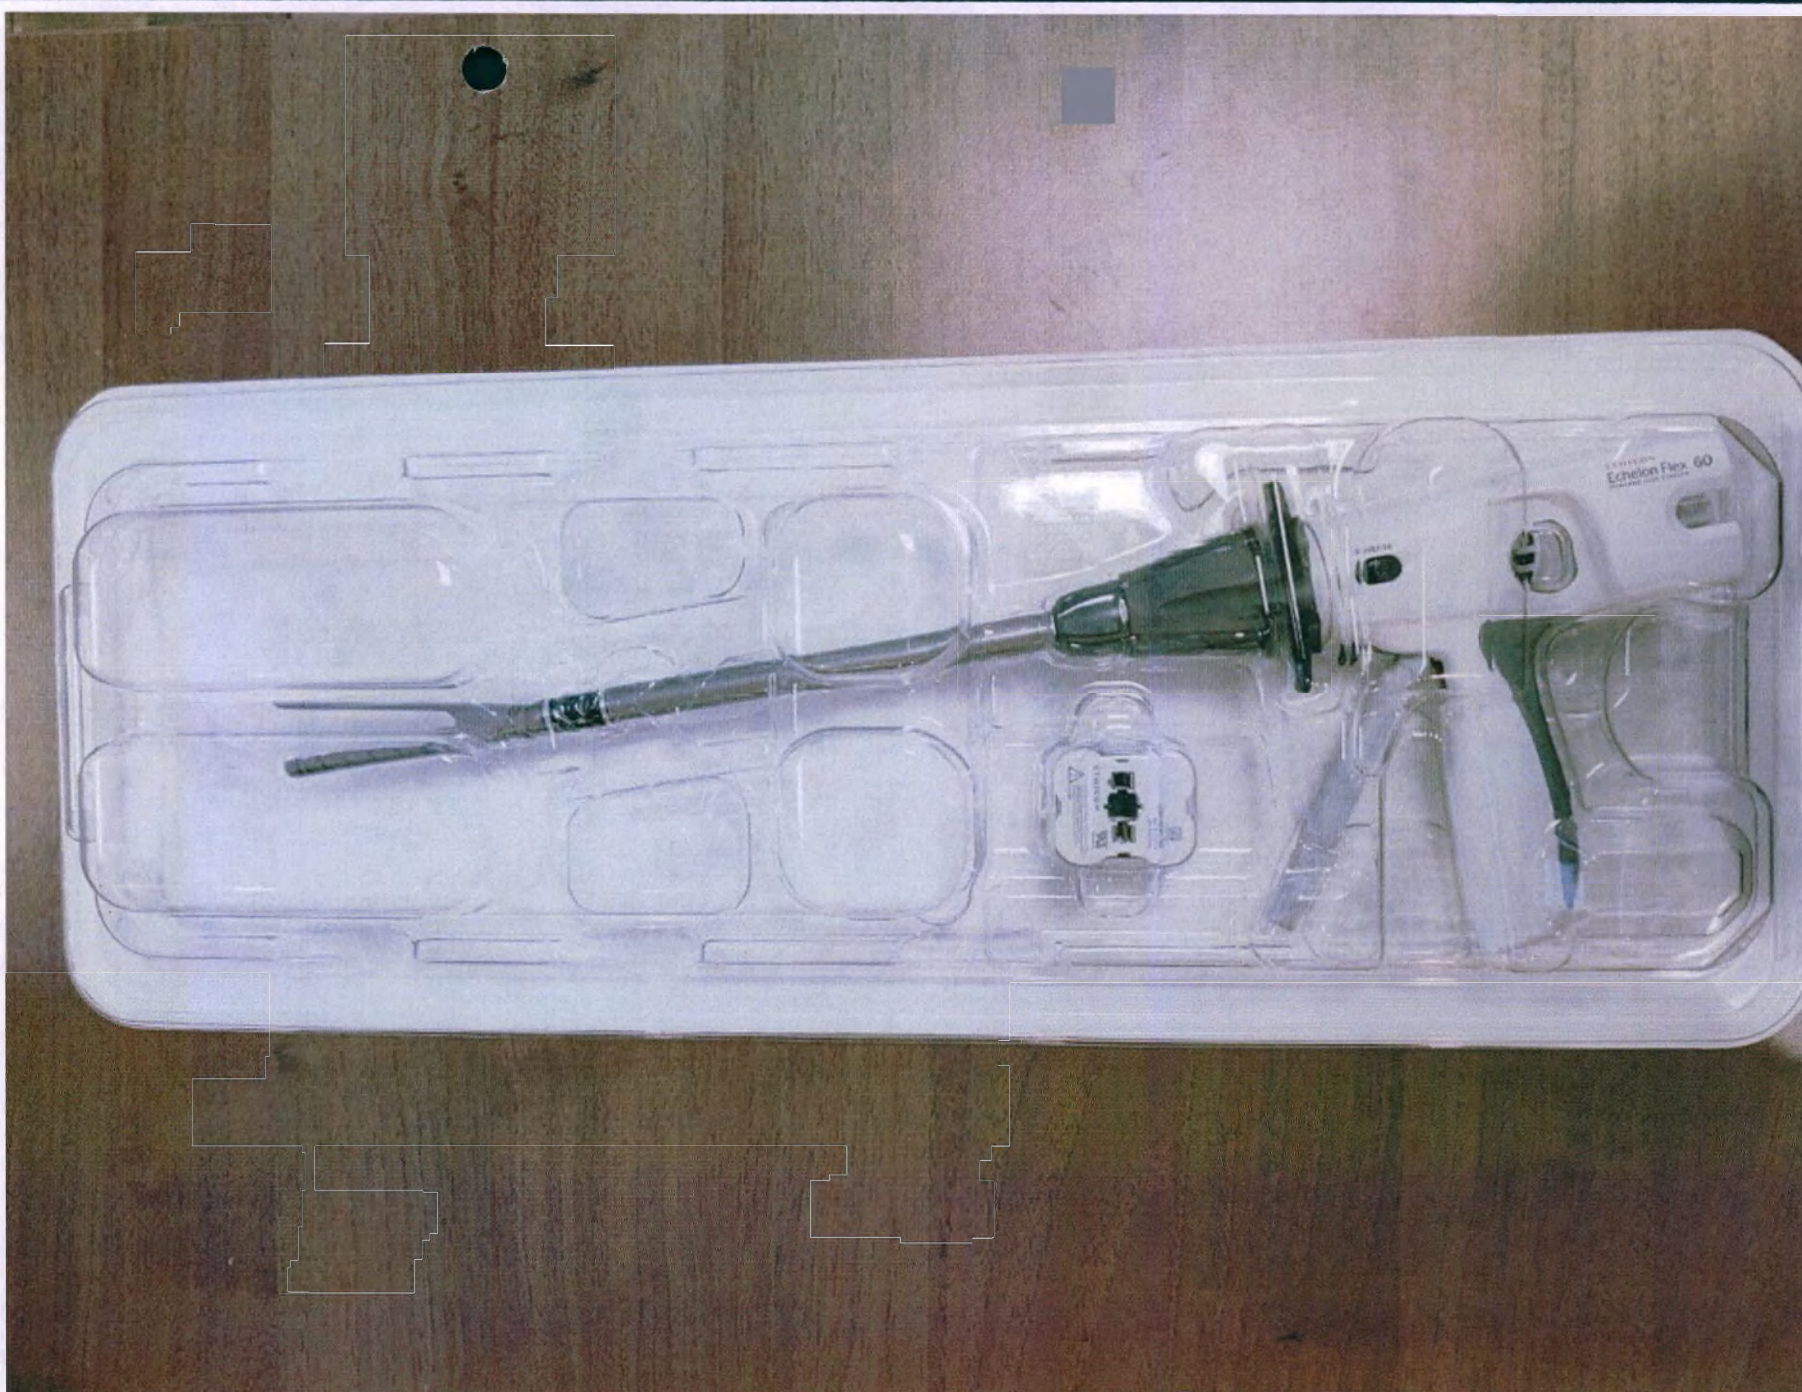


Рис. 2. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке (блистер). Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 60 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, вариант исполнения: ECHELON Flex Plus 60, длина ствола 280 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Рис. 4. Внешний вид потребительской упаковки (картонной коробки). Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 60 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, вариант исполнения: ECHELON Flex Plus 60, длина ствола 280 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.

1. Read and understand the instructions for use.
 2. Do not use if the package is damaged or the device is expired.
 3. Do not use if the device is not properly assembled.
 4. Do not use if the device is not properly calibrated.
 5. Do not use if the device is not properly maintained.
 6. Do not use if the device is not properly stored.
 7. Do not use if the device is not properly disposed of.
 8. Do not use if the device is not properly cleaned.
 9. Do not use if the device is not properly inspected.
 10. Do not use if the device is not properly tested.



ETHICON ENDO-SURGERY, LLC
 475 Calle C
 Guaynabo, PR 00969 USA
 1-877-ETHICON
 +1-513-337-8901 (English)
 2023-01-01

Assembled in Mexico
 pat. www.ethicon.com/patentmarking
 www.a-ifu.com/endo-surgery

00110705036015017
 (17)231231(10)PSAAEF

LOT PSAAEF
 2023-12-31
 00127 8908918 001 PCAB00A 00

CE 0123

ETHICON™
 PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES


 Ethicon Endo-Surgery, LLC
 475 Calle C
 Guaynabo, PR 00969 USA
 1-877-ETHICON
 +513-337-8901 (English)

EC REP
 Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH
 Hummelshuettel Str. 71
 22851 Norderstedt, GERMANY

Рис. 5. Пример маркировки на потребительской упаковке (картонной коробке). Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 60 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, вариант исполнения: ECHELON Flex Plus 60, длина ствола 280 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.

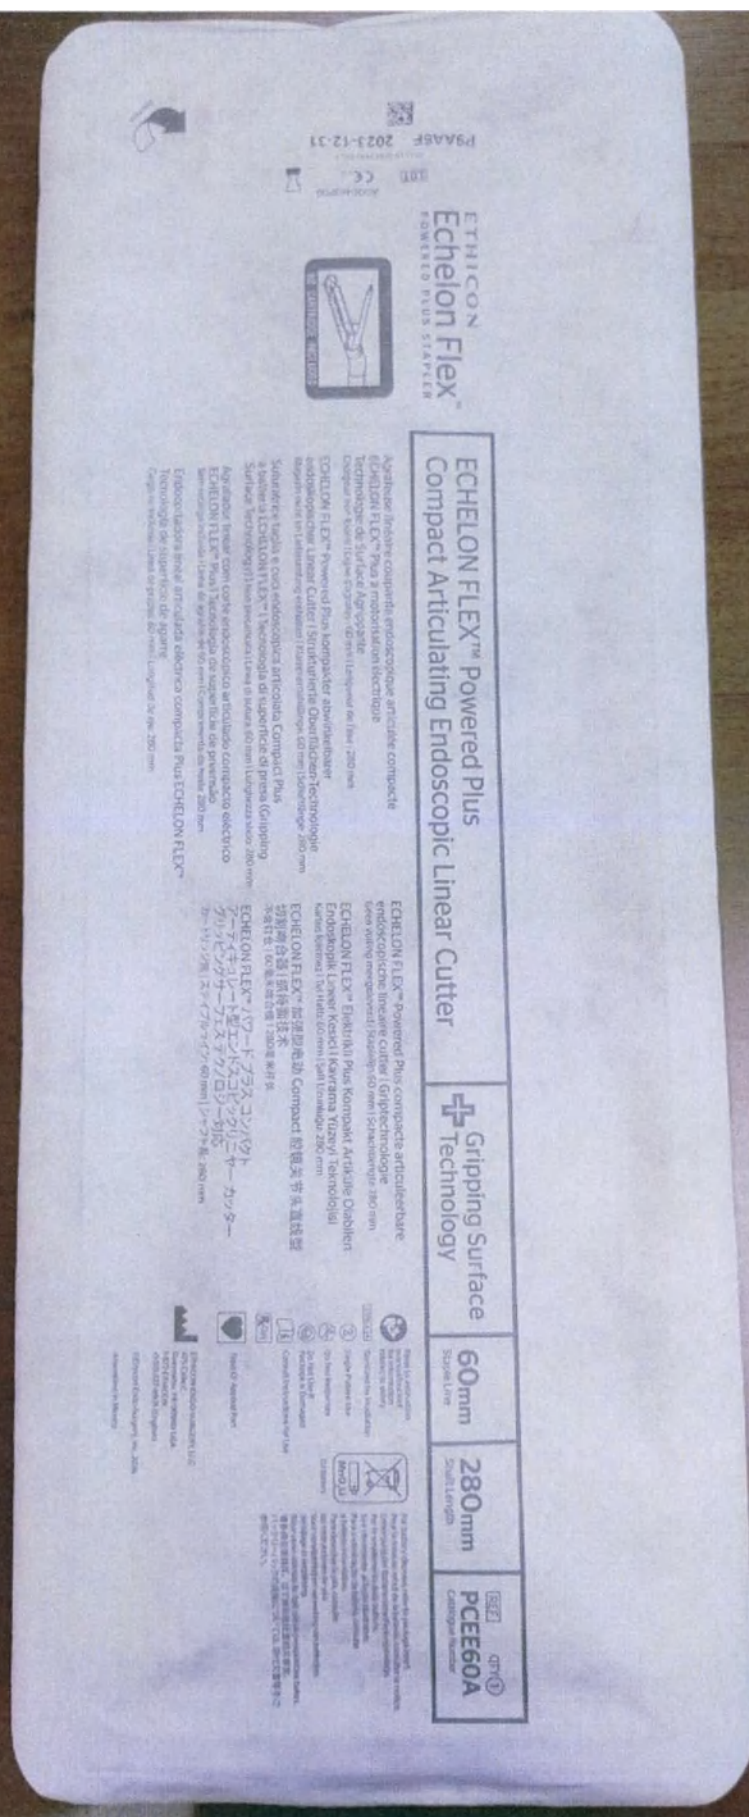


Рис. 7. Пример маркировки на первичной упаковке. Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHOLON Flex Plus 60 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, вариант исполнения: ECHOLON Flex Plus 60, длина ствола 280 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.




Рис. 8. Внешний вид медицинского изделия. Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 60 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 60, длина ствола 340 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Рис. 9. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке (блистер). Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 60 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 60, длина ствола 340 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Рис. 10. Внешний вид потребительской упаковки (картонной коробки). Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 60 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 60, длина ствола 340 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.

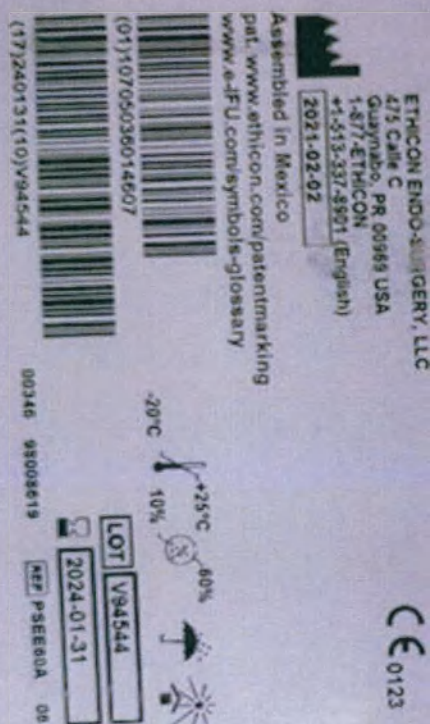

REF PSEER0A

Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHOLON Flex Plus 60 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, вариант исполнения: ECHOLON Flex Plus 60, длина ствола 340 мм.

Область применения: Хирургия.

Регистрационное удостоверение: РЗН 2017/5514 от 23.12.2019.

Этикон Эндо-Сурджери, Эл-Эл-Си*
 США, Ethicon Endo-Surgery, LLC 475
 Calle C, Guaynabo, Puerto Rico, 00968,
 USA.

Уполномоченный представитель
 производителя, адрес: ООО «Джонсон &
 Джонсон» 121614, Россия, г. Москва,
 ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел.
 +7(495)5507777.

Количество штук в упаковке: см. на упаковке.
 Упаковка не содержит радиоактивных веществ.
 Код партии: см. на упаковке.
 Дата изготовления: см. на упаковке.
 Использовать др. см. на упаковке.
 Срок годности: см. инструкцию.
 Интерпретация символов см. инструкцию.



Рис. 12. Пример маркировки на потребительской упаковке (картонной коробке). Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHOLON Flex Plus 60 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHOLON Flex Plus 60, длина ствола 340 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.

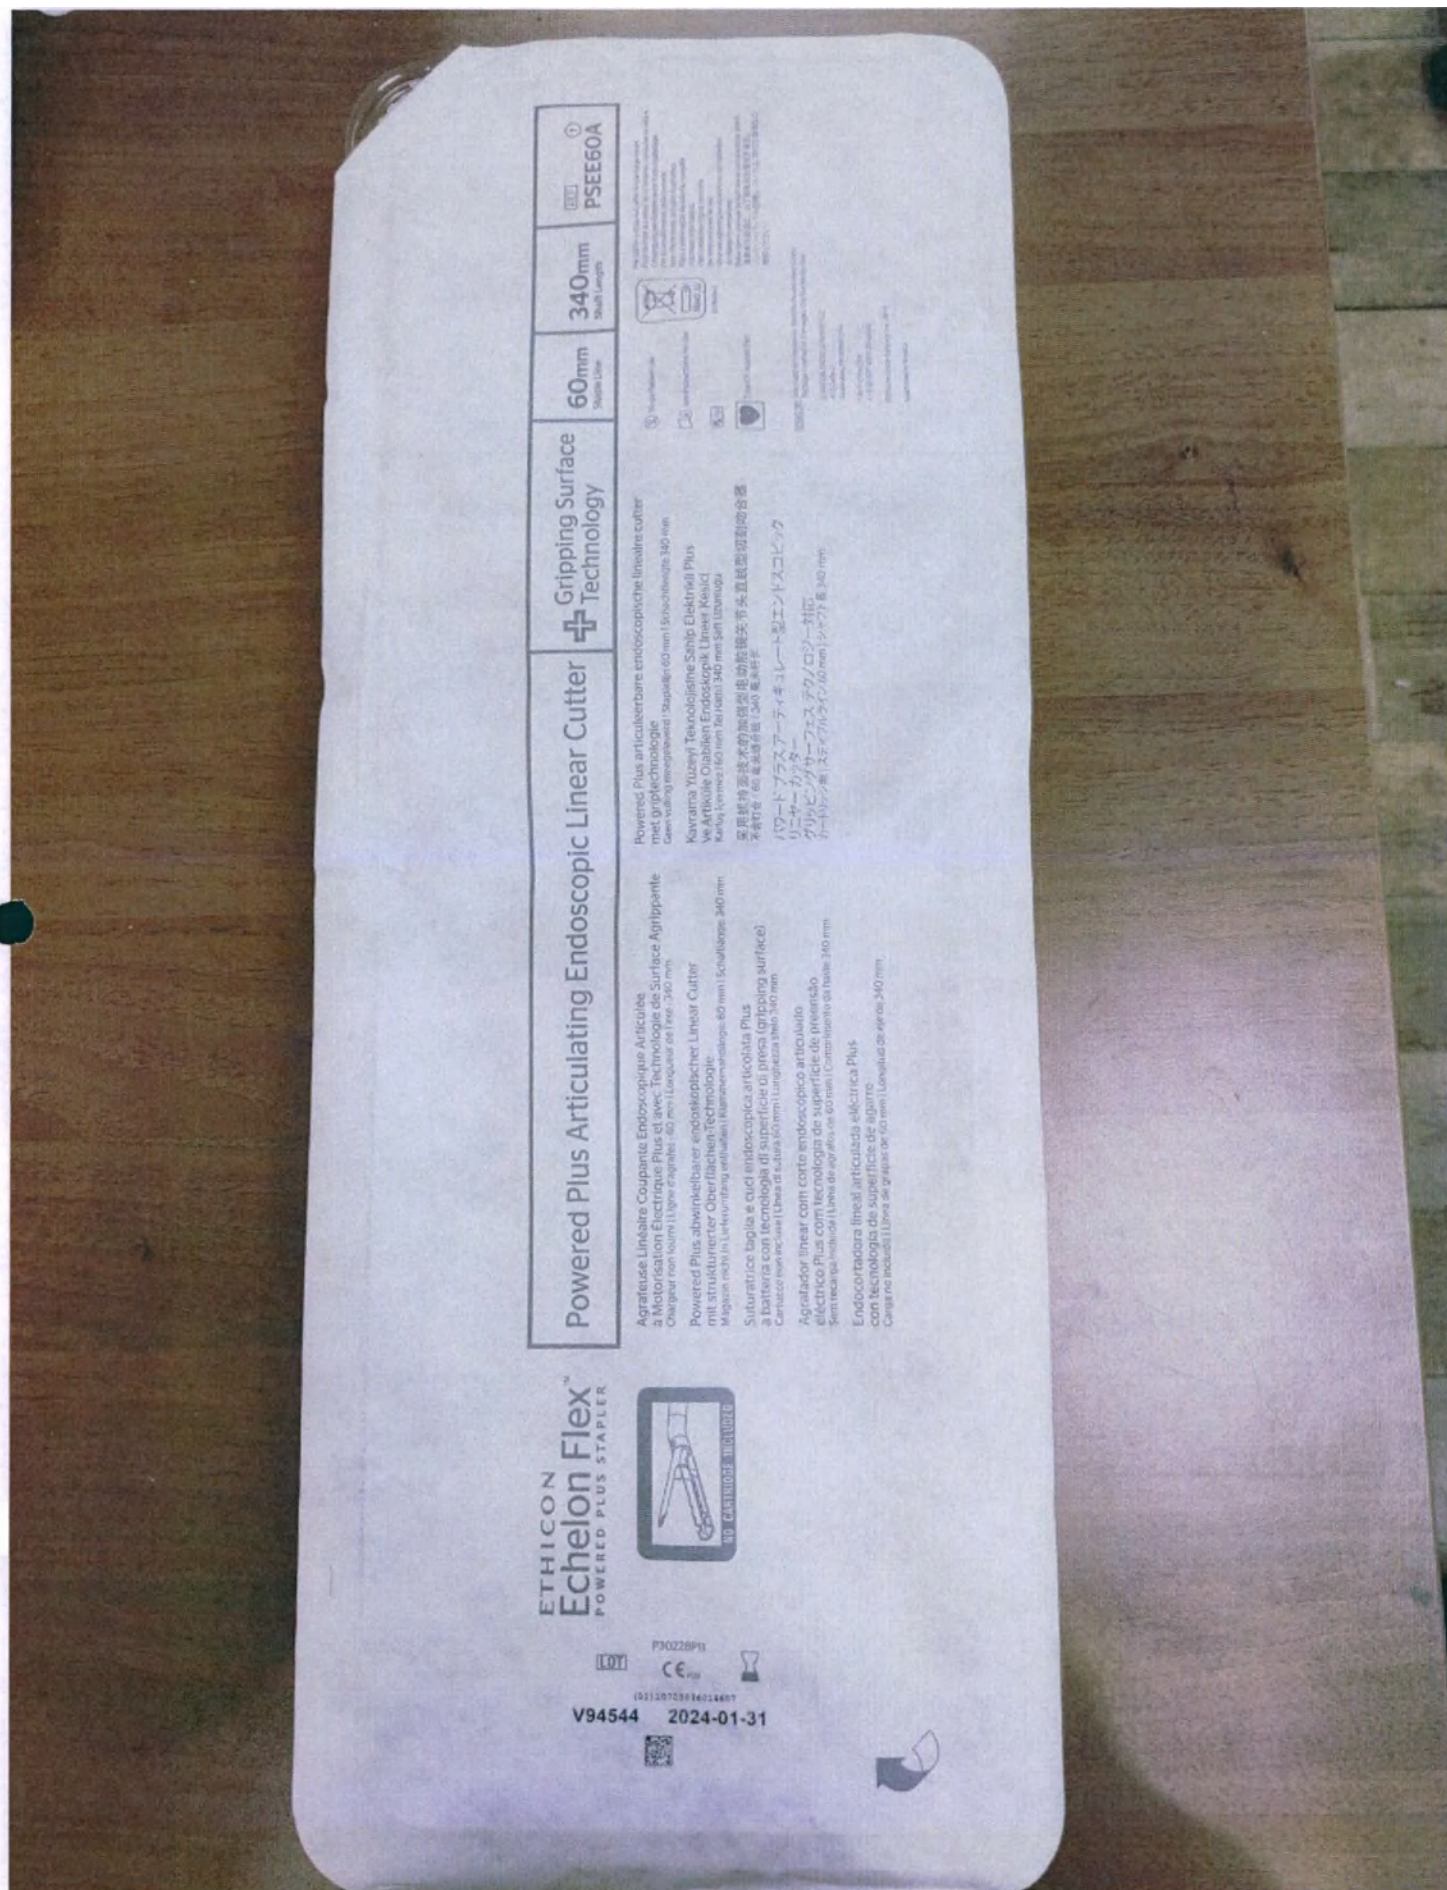


Рис. 13. Пример маркировки на первичной упаковке. Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 60 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 60, длина ствола 340 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Рис. 14. Внешний вид медицинского изделия. Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 60 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 60, длина ствола 440 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Рис. 15. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке (блистер). Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 60 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 60, длина ствола 440 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.

ETNICON ENDO-SURGERY, LLC
 475 Calle C
 Guaynabo, PR 00969 USA
 1-877-ETNICON
 +1-513-337-8901 (English)
 2021-02-08

Assembled in Mexico
 pat. www.ethicon.com/patentmarking
www.e-i-fu.com/symbols-glossary

REF PLEEBDA
 Аппарат сшивающе-режущий линейный
 ECHELON Flex Plus 60 с изменяющимся углом
 рабочей части, эндоскопический,
 электрический, автономный, закрытый
 исполнение: ECHELON Flex Plus 60, длина
 ствола 440 мм

Область применения: Хирургия
 Регистрационное удостоверение № P3H
 2017/5514 от 23.12.2019г.
 Производитель: "Этикон Эндо-Серджери
 3и-3и-Си", США, Ethicon Endo-Surgery, LLC,
 475 Calle C, Guaynabo, Puerto Rico, 00969, USA
 Уполномоченный представитель
 производитель, адрес: ООО "Джонсон &
 Джонсон", 121614, Россия, г. Москва, ул.
 Крылатская, д. 17, корп. 2, тел. +7(495)5807777
 Количество штук в упаковке: см. на упаковке
 Упаковка не содержит радиоактивных веществ
 Интерпретация символов см. инструкцию Код
 партии см. на упаковке
 Дата изготовления см. на упаковке
 Использовать до см. на упаковке
 Срок годности см. в инструкции

(01)10705036014614
 (17)240131(10)V9471W
 00232 98010210

LOT V9471W
 2024-01-31
 REF PLEEBDA 09

-20°C 10% 80%
 25°C

CE 0123


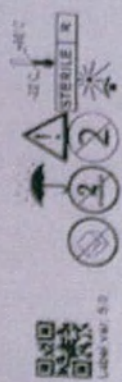


Рис. 16. Внешний вид потребительской упаковки (картонной коробки). Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 60 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 60, длина ствола 440 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.


 Manufactured by Ethicon, Inc.
 2700 Calhoun St.
 Somerville, MA 01906 USA
 1-877-ETHICON
 617-437-8800 (English)
 0021-22-08

ETHICON ENDO-SURGERY, LLC
 270 Calhoun St.
 Somerville, MA 01906 USA
 1-877-ETHICON
 617-437-8800 (English)
 0021-22-08
 Assembled in Mexico
 part name: ETHICON, complete marking
 name: ETHICON, complete marking

CE 0123



ETHICON™
 PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES



Ethicon Endo-Surgery, LLC
 270 Calhoun St.
 Somerville, MA 01906 USA
 1-877-ETHICON
 617-437-8800 (English)



Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH
 Hohenhofweg 21
 22829 Norderstedt, GERMANY

Рис. 17. Пример маркировки на потребительской упаковке (картонной коробке). Аппарат швико-режущий линейный ECHELON Flex Plus 60 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 60, длина ствола 440 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Аппарат олигактиль-дефектный типичный
ECHELON Flex Plus 60 с изменяющимся углом
рабочей части, автономный, вариант
электрический, автономный, вариант
корпуса 440 мм
Область применения: Хирургия
Регистрационное удостоверение № РЗН
2017/5514 от 23.12.2019г.
Производитель: "Этикон-Эндо-Серджери"
3n-3n-Сн, США, Ethicon Endo-Surgery, LLC,
475 Calle C, Guaynabo, Puerto Rico, 00969, USA
Уполномоченный представитель
ООО "Джонсон &
Джонсон", 121514, Россия, г. Москва, ул.
Крылатская, д. 17, корп. 2, тел. +7(495)5807777
Копинство штих в упаковке см. на упаковке
Упаковка не содержит раздаточных веществ
Информацию см. на упаковке см. инструкцию код
партни. см. на упаковке
Дата изготовления: см. на упаковке
Использовать до: см. на упаковке
Срок годности: см. в инструкции

 **ETHICON ENDO-SURGERY, LLC**
475 Calle C
Guaynabo, PR 00969 USA
1-877-ETHICON
+1-513-337-8901 (English)
2021-02-08

Assembled in Mexico
pat. www.ethicon.com/patentmarking
www.e-IFU.com/symbols-glossary

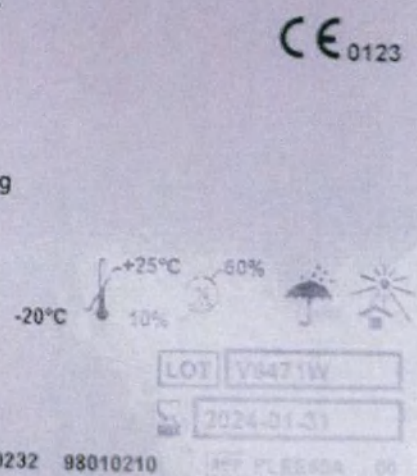


Рис. 18. Пример маркировки на потребительской упаковке (картонной коробке). Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 60 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 60, длина ствола 440 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.

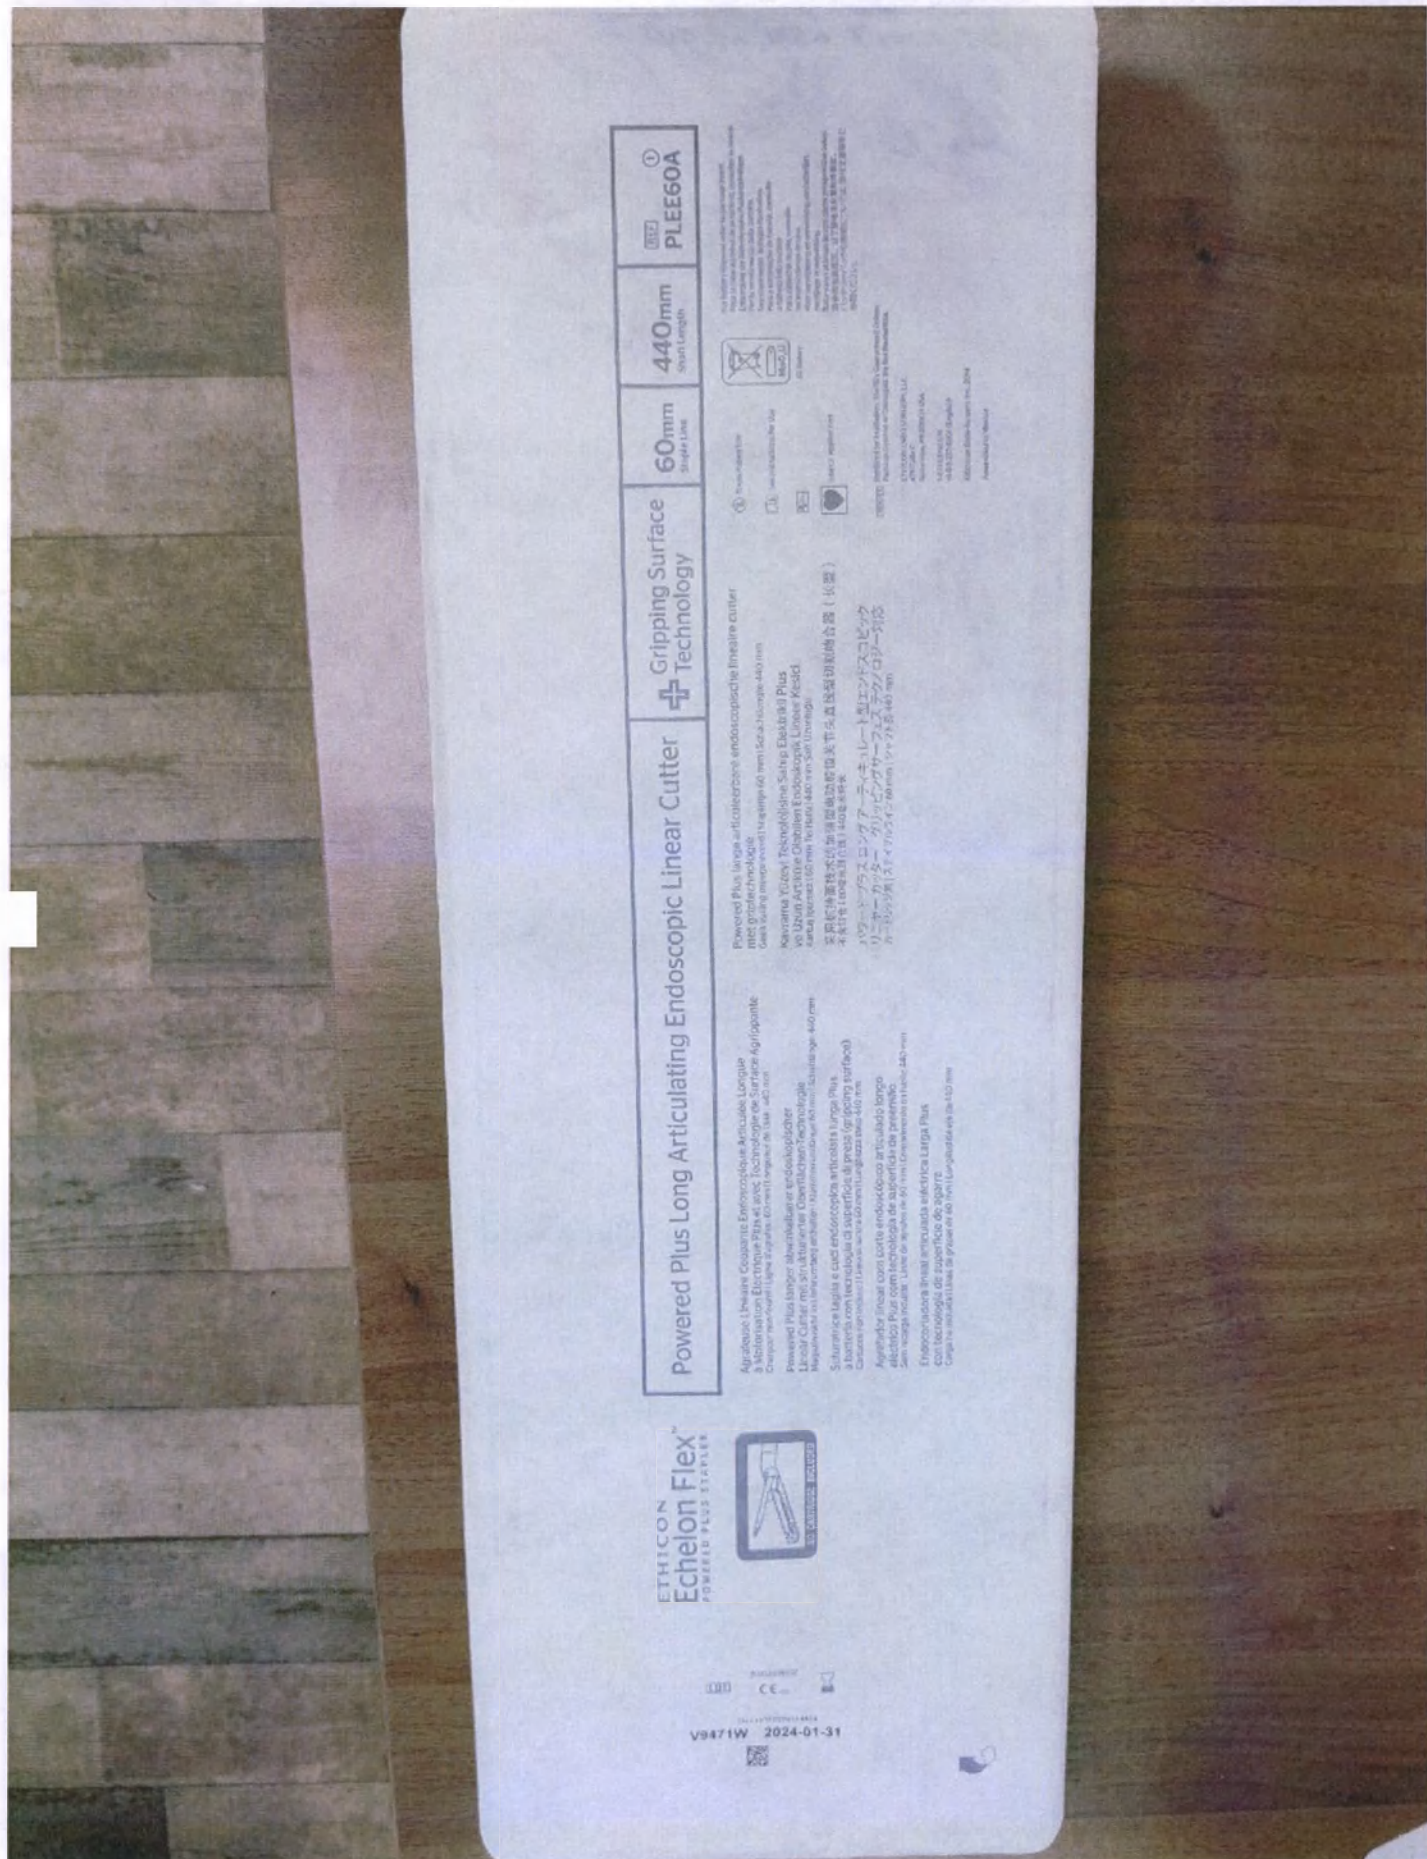


Рис. 19. Пример маркировки на первичной упаковке. Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 60 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 60, длина ствола 440 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Рис. 20. Внешний вид медицинского изделия. Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 45 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 45, длина ствола 280 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Рис. 21. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке (блистер). Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 45 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 45, длина ствола 280 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Рис. 22. Внешний вид потребительской упаковки (картонной коробки). Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 45 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 45, длина ствола 280 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.

ETHICON ENDO-SURGERY, LLC
475 Calle C
Guaynabo, PR 00969 USA
1-877-ETHICON
+1-313-337-6901 (English)
2021-02-02


Assembled in Mexico
pat. www.ethicon.com/patentmarking
www.aifu.com/symbols-glossary



10110705036015338



117126013110/V9454A



LOT V9454A

2024-01-31

00294 990C8618 REF PCE45A 03

CE 0123

2021-02-02
Ethicon Endo-Surgery, LLC
475 Calle C
Guaynabo, PR 00969 USA
1-877-ETHICON
+1-313-337-6901 (English)
2021-02-02
Assembled in Mexico
pat. www.ethicon.com/patentmarking
www.aifu.com/symbols-glossary
10110705036015338
117126013110/V9454A
00294 990C8618 REF PCE45A 03
CE 0123
Lot: V9454A
Exp: 2024-01-31
REF: PCE45A 03

ETHICON™

PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES



Ethicon Endo-Surgery, LLC
475 Calle C
Guaynabo, PR 00969 USA
1-877-ETHICON
+1-313-337-6901 (English)

EC REP

Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH
Hummelsbütteler Steinlamm 71
22851 Norderstedt, GERMANY

Рис. 23. Пример маркировки на потребительской упаковке (картонной коробке). Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 45 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 45, длина ствола 280 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.

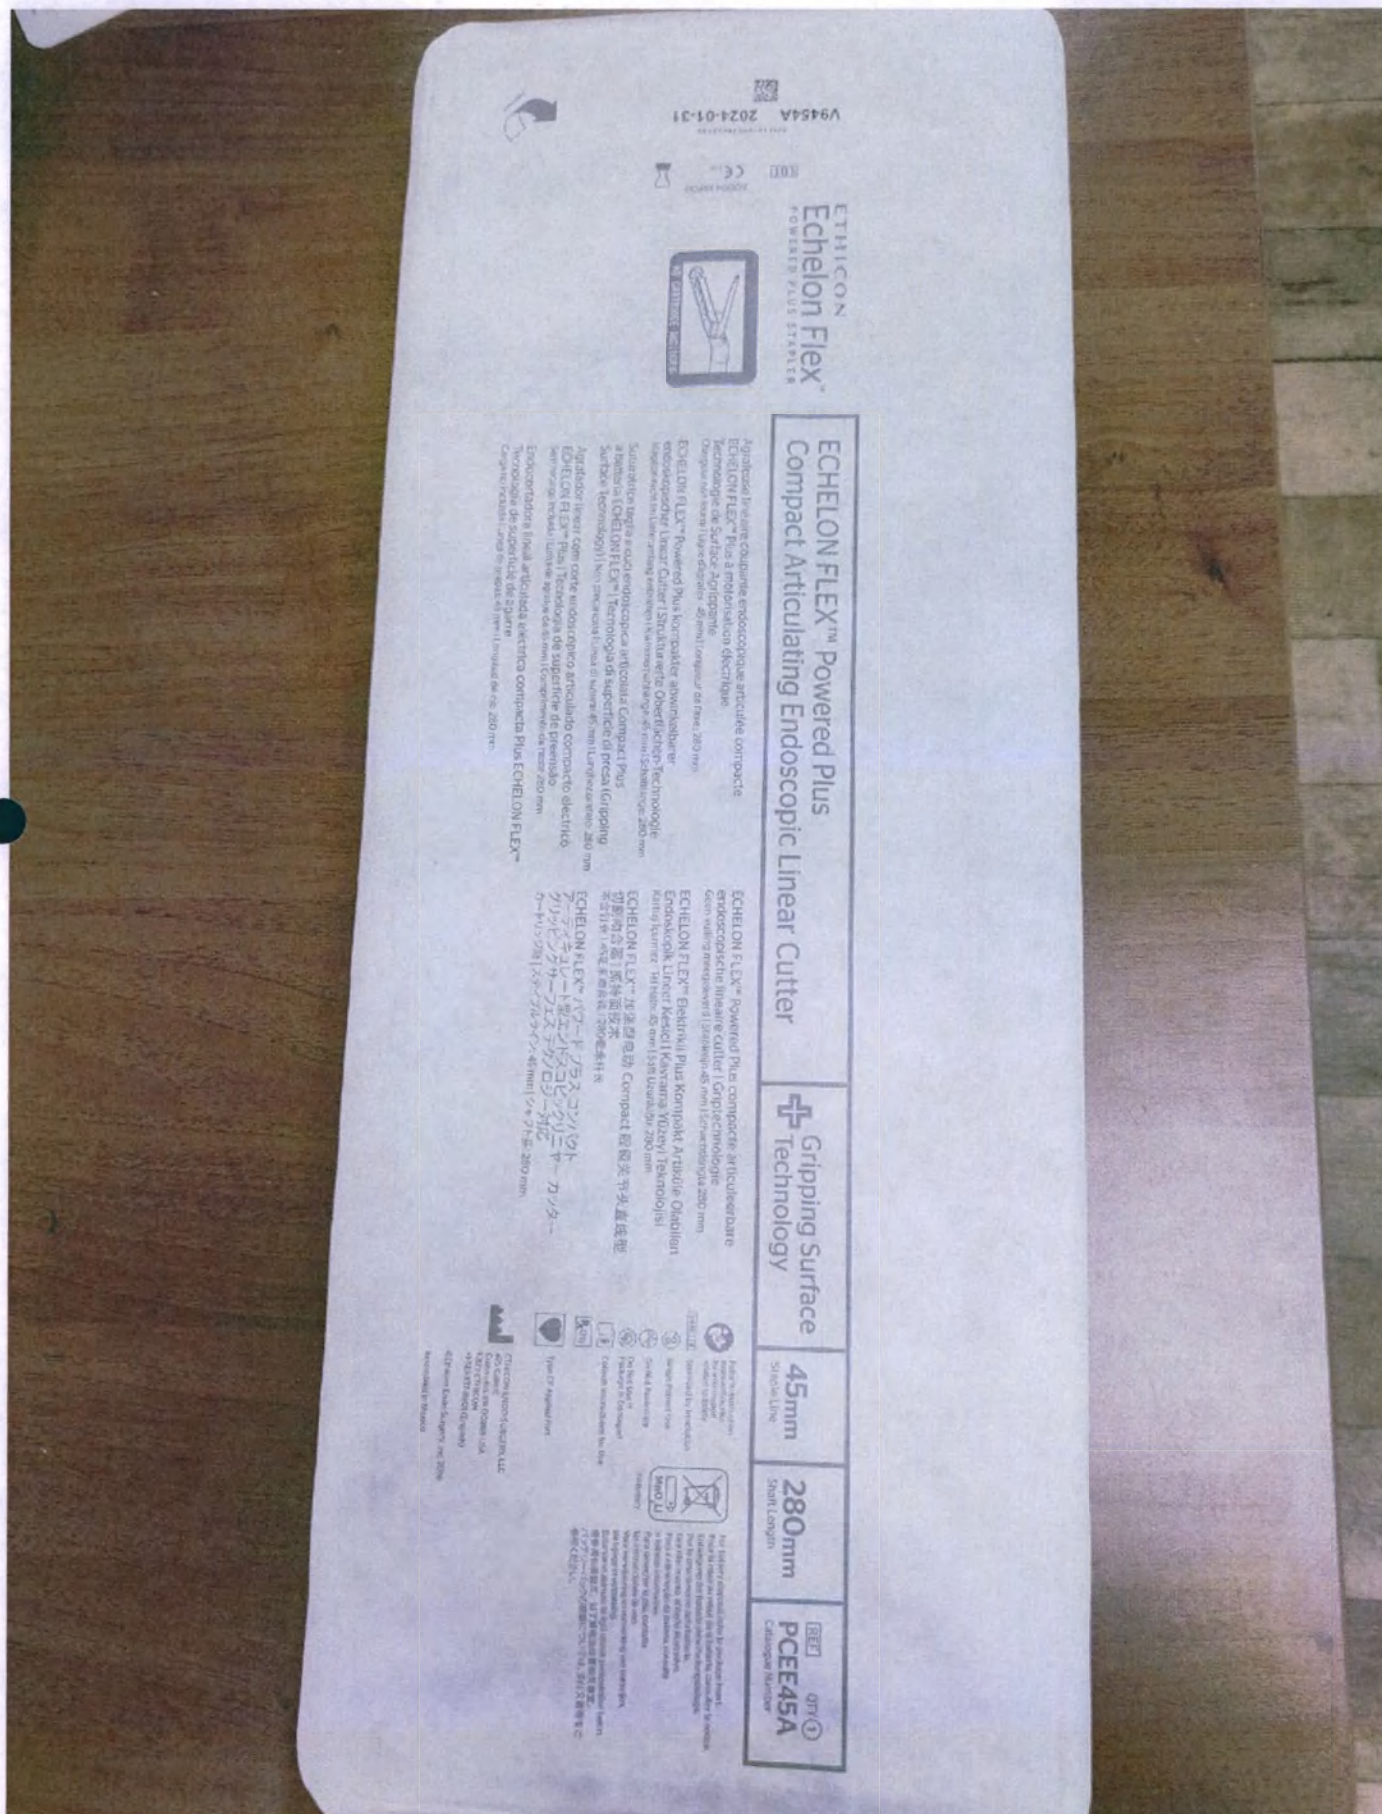


Рис. 25. Пример маркировки на первичной упаковке. Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 45 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 45, длина ствола 280 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Рис. 26. Внешний вид медицинского изделия. Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 45 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 45, длина ствола 340 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Рис. 27. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке (блистер). Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 45 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 45, длина ствола 340 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Рис. 28. Внешний вид потребительской упаковки (картонной коробки). Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 45 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 45, длина ствола 340 мм – 3 шт. уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.

ETHICON ENDO-SURGERY, LLC
575 Calle C
Guaynabo, PR 00988 USA
1-877-ETHICON
+1-953-337-8801 (English)
9202-99-97

Assembled in Mexico
pat. www.ethicon.com/patentmarking
www.e-ifu.com/symbols-glossary

(01)10705026015302

(17)240135(10)V04548

00561 94006010 REF. PSEE45A 02

ETHICON™
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES



Рис. 29. Пример маркировки на потребительской упаковке (картонной коробке). Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 45 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 45, длина ствола 340 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Рис. 32. Внешний вид медицинского изделия. Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 45 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 45, длина ствола 440 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Рис. 33. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке (блистер). Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 45 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 45, длина ствола 440 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Рис. 34. Внешний вид потребительской упаковки (картонной коробки). Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 45 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 45, длина ствола 440 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Рис. 35. Пример маркировки на потребительской упаковке (картонной коробке). Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 45 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 45, длина ствола 440 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.

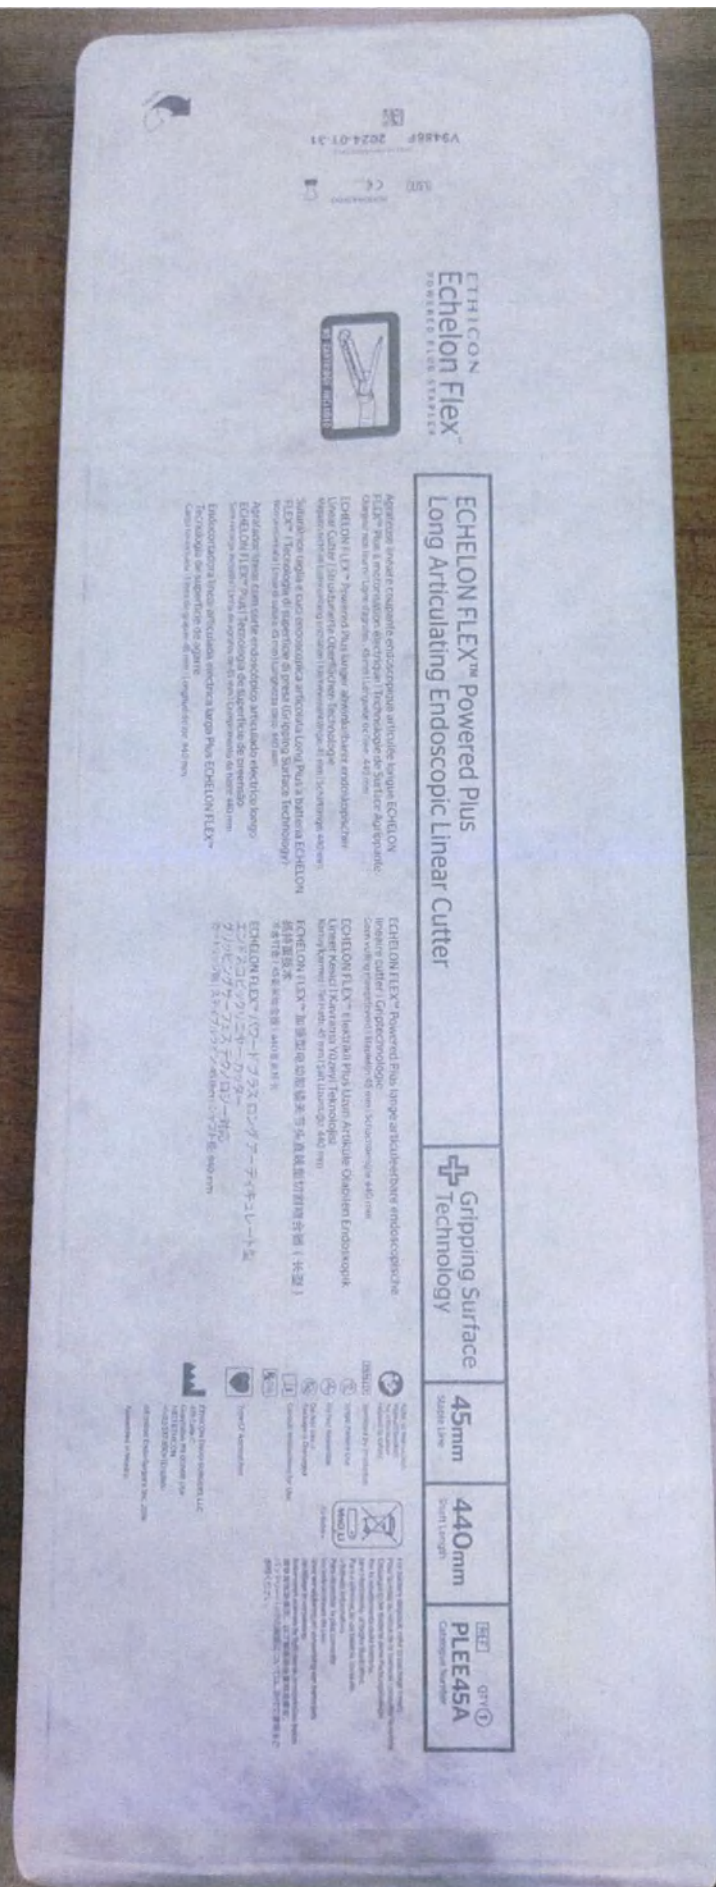


Рис. 37. Пример маркировки на первичной упаковке. Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 45 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, варианты исполнения: ECHELON Flex Plus 45, длина ствола 440 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Рис. 38. Внешний вид медицинского изделия. Аппарат сшивающе-режущий усовершенствованный, с клювовидной браншей ECHELON Flex 35 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, длина ствола 320 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Рис. 39. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке (блистер). Аппарат сшивающе-режущий усовершенствованный, с клювовидной браншей ECHELON Flex 35 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, длина ствола 320 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Рис. 40. Внешний вид потребительской упаковки (картонной коробки). Аппарат сшивающе-режущий усовершенствованный, с клювовидной браншей ECHELON Flex 35 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, длина ствола 320 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.


ETHICON ENDO-SURGERY, LLC Guaynabo, Puerto Rico 00969 USA
Assembled in Mexico
pat. www.ethicon.com/patentmarking




(01)10705036014584



(17)240131(10)V9455E



Temperature
Limit



Humidity
Limitation



Keep
Dry



Keep Away
From Heat



0123

LOT V9455E

2024-01-31

Use-By Date

00472

98010210

REF

PVE35A

05

ETHICON™
PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES



Ethicon Endo-Surgery, LLC
475 Calle C
Guaynabo, PR 00969 USA
1-877-ETHICON
+1-513-337-8901 (English)

EC REP

Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH
Hummelsbueteler Steindamm 71
22851 Norderstedt, GERMANY

Рис. 41. Пример маркировки на потребительской упаковке (картонной коробке). Аппарат сшивающе-режущий усовершенствованный, с клювовидной браншей ECHELON Flex 35 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, длина ствола 320 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.

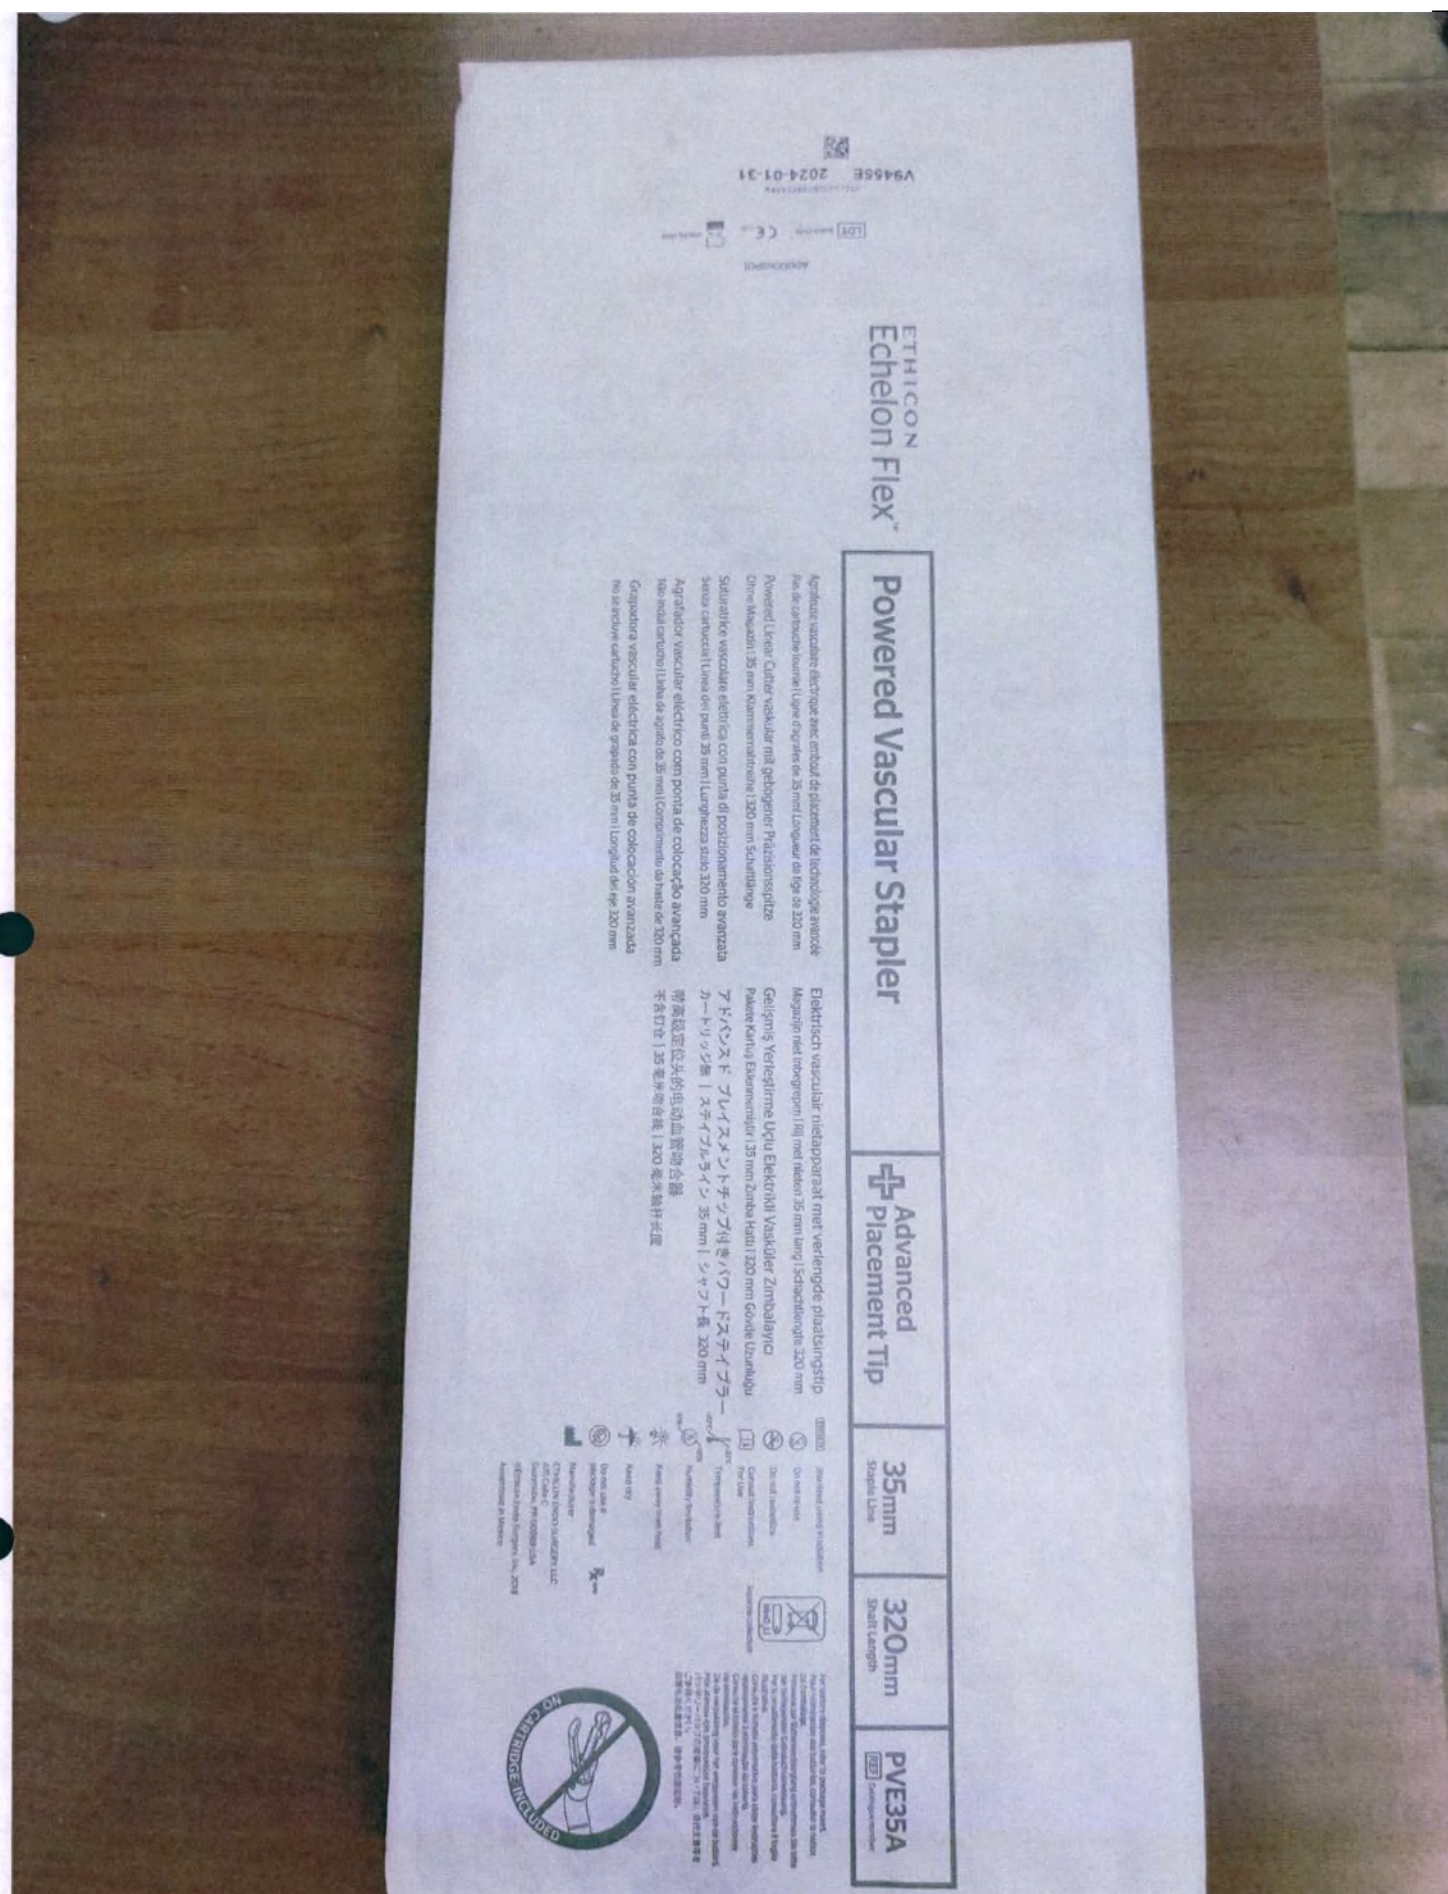


Рис. 42. Пример маркировки на первичной упаковке. Аппарат сшивающе-режущий усовершенствованный, с клювовидной браншей ECHELON Flex 35 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, длина ствола 320 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Рис. 43. Внешний вид медицинского изделия. Кассета ENDOPATH ECHELON 35 мм, 4 ряда, белая - 12 шт./уп. с инструкцией по применению – 1 шт./уп.



Рис. 44. Общий вид медицинского изделия в первичной упаковке (блистер). Кассета ENDOPATH ECHELON 35 мм, 4 ряда, белая - 12 шт./уп. с инструкцией по применению – 1 шт./уп.



Рис. 45. Внешний вид потребительской упаковки (картонной коробки). Кассета ENDOPATH ECHELON 35 мм, 4 ряда, белая - 12 шт./уп. с инструкцией по применению – 1 шт./уп.

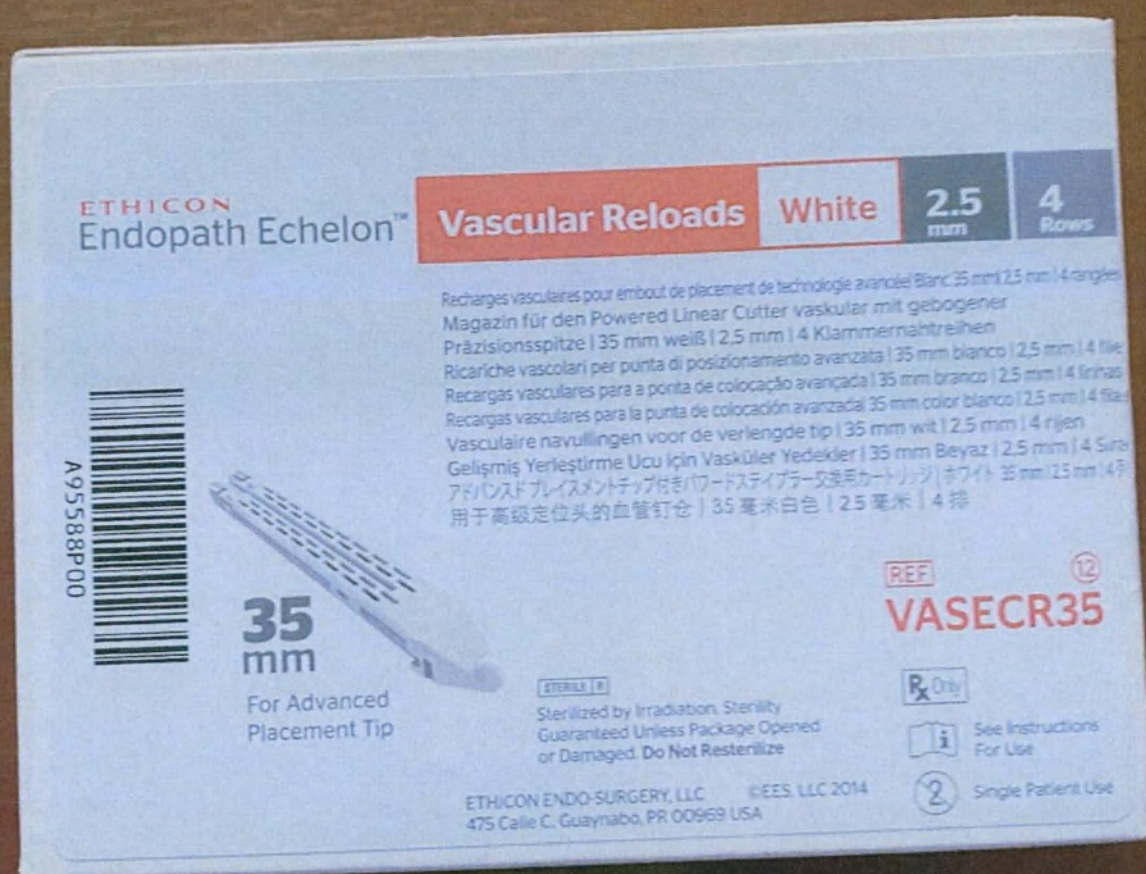


Рис. 46. Пример маркировки на потребительской упаковке (картонной коробке). Кассета ENDOPATH ECHELON 35 мм, 4 ряда, белая - 12 шт./уп. с инструкцией по применению – 1 шт./уп.

ETHICON

PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES



See Instructions For Use



Ethicon Endo-Surgery, LLC
475 Calle C
Guaynabo, PR 00969 USA



Ethicon Endo-Surgery, Inc.
4545 Creek Road
Cincinnati, OH 45242-2839 USA
1-877-ETHICON



Ethicon Endo-Surgery (Europe) GmbH
Hummelsbuetteler Steindamm 71
22851 Norderstedt, GERMANY

Рис. 47. Пример маркировки на потребительской упаковке (картонной коробке). Кассета ENDOPATH ECHELON 35 мм, 4 ряда, белая - 12 шт./уп. с инструкцией по применению – 1 шт./уп.



Рис. 48. Пример маркировки на потребительской упаковке (картонной коробке). Кассета ENDOPATH ECHELON 35 мм, 4 ряда, белая - 12 шт./уп. с инструкцией по применению – 1 шт./уп.



Рис. 49. Пример маркировки на первичной упаковке. Кассета ENDOPATH ECHELON 35 мм, 4 ряда, белая - 12 шт./уп. с инструкцией по применению – 1 шт./уп.



Рис. 50. Транспортировочная (торговая) упаковка. Аппарат сшивающе-режущий усовершенствованный, с клювовидной branшей ECHELON Flex 35 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, длина ствола 320 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.



Рис. 51. Маркировка транспортировочной (торговой) упаковки. Аппарат сшивающе-режущий усовершенствованный, с клювовидной branшей ECHELON Flex 35 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, длина ствола 320 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.

REF PLEE60A

Аппарат сшивающе-режущий линейный
ECHELON Flex Plus 60 с изменяющимся углом
рабочей части, эндоскопический,
электрический, автономный, вариант
исполнения: ECHELON Flex Plus 60, длина ствола
280 мм – 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп.,
инструкция по применению – 1 шт./уп.

Номинальная мощность – 40 Вт

Область применения: хирургия. Срок годности: 3 года.

Регистрационное удостоверение: РЗН 2017/5514 от
XX.XX.XXXX г.



Производитель: Ethicon Endo-Surgery, LLC,
475 Calle C, Guaynabo, Puerto Rico 00969 USA (США)

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, Россия, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел.: +7(495)5807777

Количество штук в упаковке – см. на упаковке.

Упаковка не содержит радиоактивных веществ.

Интерпретацию символов см. инструкцию.

Код партии – см. на упаковке.

Использовать до (ГГГГ-ММ-ДД) – см. на упаковке



Label ver. XX



Рис. 52. Проект русскоязычной маркировки. Аппарат сшивающе-режущий линейный ECHELON Flex Plus 60 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, вариант исполнения: ECHELON Flex Plus 60, длина ствола 280 мм 3 шт./уп., аккумулятор – 3 шт./уп., инструкция по применению – 1 шт./уп.

REF VASECR35

Кассета к аппарату сшивающе-режущему усовершенствованному, с клювовидной браншей ECHELON Flex 35 с изменяющимся углом рабочей части, эндоскопический, электрический, автономный, длина ствола 320 мм: Кассета ENDOPATH ECHELON 35 мм, 4 ряда, белая – 12 шт./уп. с инструкцией по применению - 1шт./уп.

Область применения: хирургия. Срок годности: 3 года.
Регистрационное удостоверение: РЗН 2017/5514 от
XXXXXXX г.

Производитель: Ethicon Endo-Surgery, LLC,
475 Calle C, Guaynabo, Puerto Rico 00969 USA (США)
Уполномоченный представитель производителя:
ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, Россия, г. Москва,
ул. Крылатская, д. 17, корп. 2, тел.: +7(495)5807777
Количество штук в упаковке – см. на упаковке.
Упаковка не содержит радиоактивных веществ.
Интерпретацию символов см. инструкцию.
Код партии – см. на упаковке.
Использовать до (ГГГГ-ММ-ДД) – см. на упаковке



Label ver. XX



Рис. 53. Проект русскоязычной маркировки. Кассета ENDOPATH ECHELON 35 мм, 4 ряда, белая - 12 шт./уп. с инструкцией по применению – 1 шт./уп.



ПРОДАТ
ОКРЕДНЕН
ПЕЧАТЬ
МЕСТО
53