



Р-ФАРМ
Инновационные
технологии
здоровья

Акционерное общество «Р-Фарм»

123154, г. Москва, ул. Берзарина,
д. 19, корп. 1

+7 (495) 956 79 37

info@rpharm.ru

Фотографические изображения медицинского изделия

Нож диатермический одноразовый стерильный
для эндоскопических вмешательств,

производства FUJIFILM Corporation

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель группы регистрации
медицинских изделий Департамента
регистрации лекарственных средств и
медицинских изделий Медицинской дирекции АО «Р-Фарм»

Е.И. Гелак

«24» октября 2023 г.

**Нож диатермический одноразовый стерильный для эндоскопических
вмешательств:**

Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани XXXXXXXX

Производитель:	ФУДЖИФИЛЬМ	FUJIFILM
	Корпорейшн,	Corporation,
Страна	Япония	Japan
происхождения:		
Уполномоченный	АО «Р-Фарм»	
представитель	123154, Москва,	
производителя в	ул. Берзарина, д. 19, корп. 1,	
РФ:	тел. 8-495-956-79-37	
	факс: 8-495-956-79-38	
	e-mail: info@rpharm.ru	

Регистрационное удостоверение

№ _____ от _____ г.

**Нож диатермический одноразовый стерильный для эндоскопических
вмешательств:**

**Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции,
авульсии ткани, остановки кровотечения XXXXXXXX**

Производитель:	ФУДЖИФИЛЬМ	FUJIFILM
	Корпорейшн,	Corporation,
Страна	Япония	Japan
происхождения:		
Уполномоченный	АО «Р-Фарм»	
представитель	123154, Москва,	
производителя в	ул. Берзарина, д. 19, корп. 1,	
РФ:	тел. 8-495-956-79-37	
	факс: 8-495-956-79-38	
	e-mail: info@rpharm.ru	


Регистрационное удостоверение

№ _____ от _____ г.




FUJIFILM Corporation

26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku
Tokyo 106-8620, Japan



FUJIFILM Europe GmbH

Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen, Germany



FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG

Sumpfstrasse 13, 6312 Steinhausen, Switzerland

Imported to Australia by :


FUJIFILM Australia Pty Ltd

54 Waterloo Road Macquarie Park, NSW 2113
Australia

1. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N10- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)

FUJIFILM

FT



2.7mm
1.0mm



DK2618J -N10-

Diathermic Slitter

en : Diathermic Slitter
 de : Diathermische Sonde
 fr : Couteau diathermique
 it : Bisturi diatermico
 es : Bisturí diatérmico
 pt : Cortador diatérmico
 nl : Diathermische snijmachine
 tr : Diyatermik Dilici



≥2.8mm



1800mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
 de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
 fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
 it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
 es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
 pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
 nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
 tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 1800mm
 de : Arbeitslänge : 1800mm
 fr : Longueur utile : 1800mm
 it : Lunghezza utile di lavoro : 1800mm
 es : Longitud de trabajo : 1800mm
 pt : Comprimento de trabalho : 1800mm
 nl : Werklengte : 1800mm
 tr : Çalışma uzunluğu : 1800mm

1 pc.

-10°C  +45°C

30%  95%

70kPa  106kPa



en : Stored in a package box
 de : In einer Produktverpackung
 aufbewahrt
 fr : Rangé dans une boîte
 d'emballage

it : Conservato in una scatola della
 confezione
 es : Almacenado en un embalaje
 pt : Guardado numa embalagem
 nl : Opgeslagen in een bewaardoos
 tr : Ambalajda saklı

 **STERILE EO**

 **i**

CE 0123


 **2016-11**

 **2013-12**

LOT 1312A1

MADE IN JAPAN
 1312A1

1. Пож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N10- (1 шт./уп.) - (общий вид упаковки/картонной коробки)

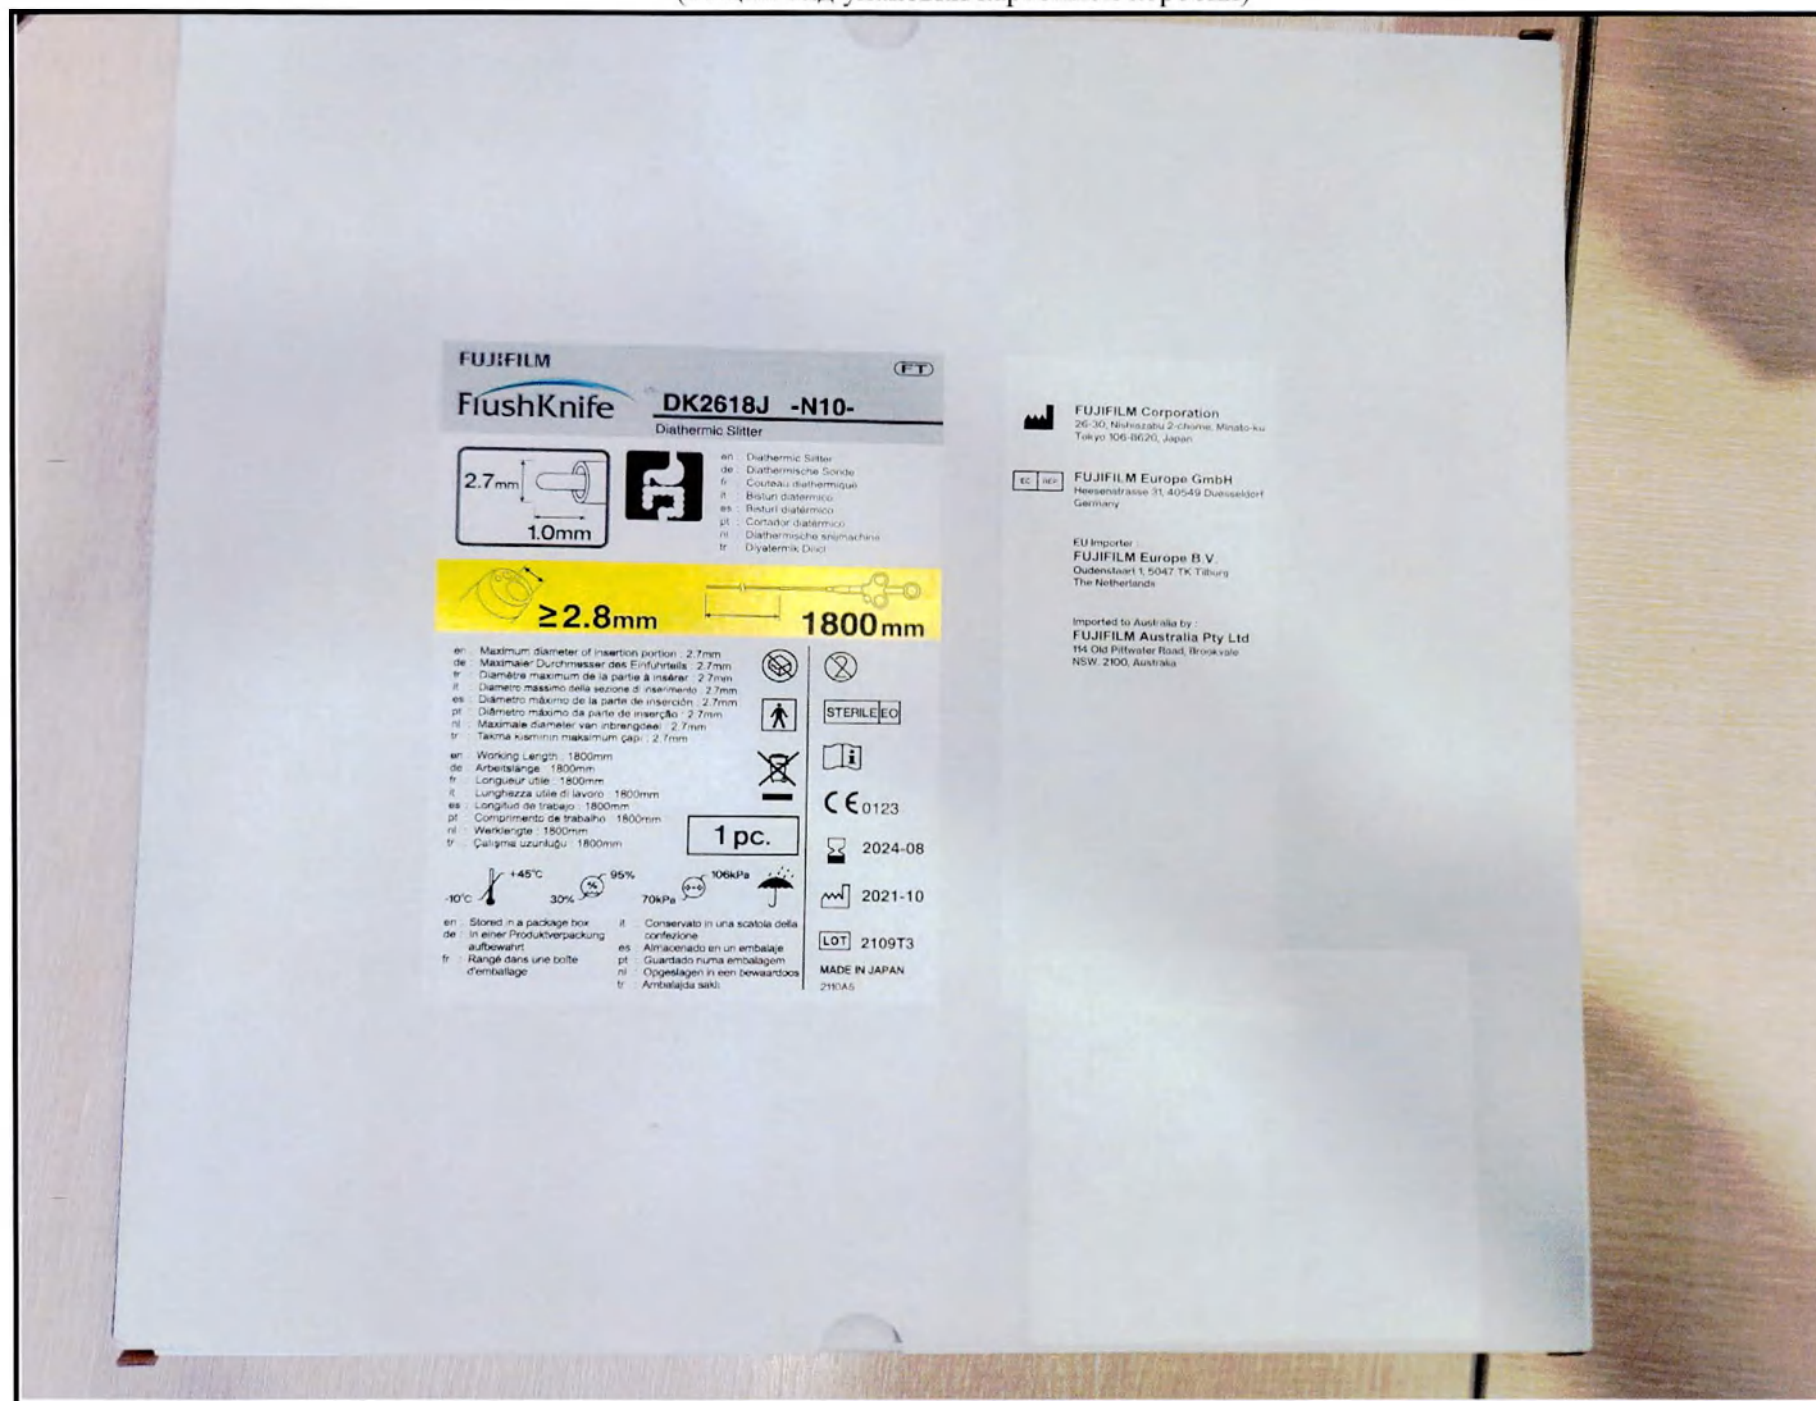

1. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N10- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)


FUJIFILM

FT

FlushKnife

DK2618J -N10-


Diathermic Slitter



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Dilyatermik Dilici



≥ 2.8mm

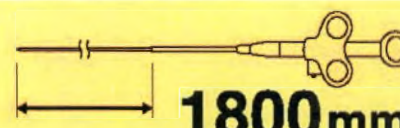

1800mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 1800mm
de : Arbeitslänge : 1800mm
fr : Longueur utile : 1800mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 1800mm
es : Longitud de trabajo : 1800mm
pt : Comprimento de trabalho : 1800mm
nl : Werklengte : 1800mm
tr : Çalışma uzunluğu : 1800mm



STERILE EO



CE 0123

2016-11

2013-12

LOT 1312A1

MADE IN JAPAN
1312A1

GS1-128




(01) 0464741 0324136 (17) 161100 (10) 1312A1

DK2618J -N10- FF827A PI-0


1. Нож для абляции, надреза, иссечения и аульсии ткани DK2618J-N10- (1 шт./уп.) - стерильная упаковка



1. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N10- (1 шт./уп.);

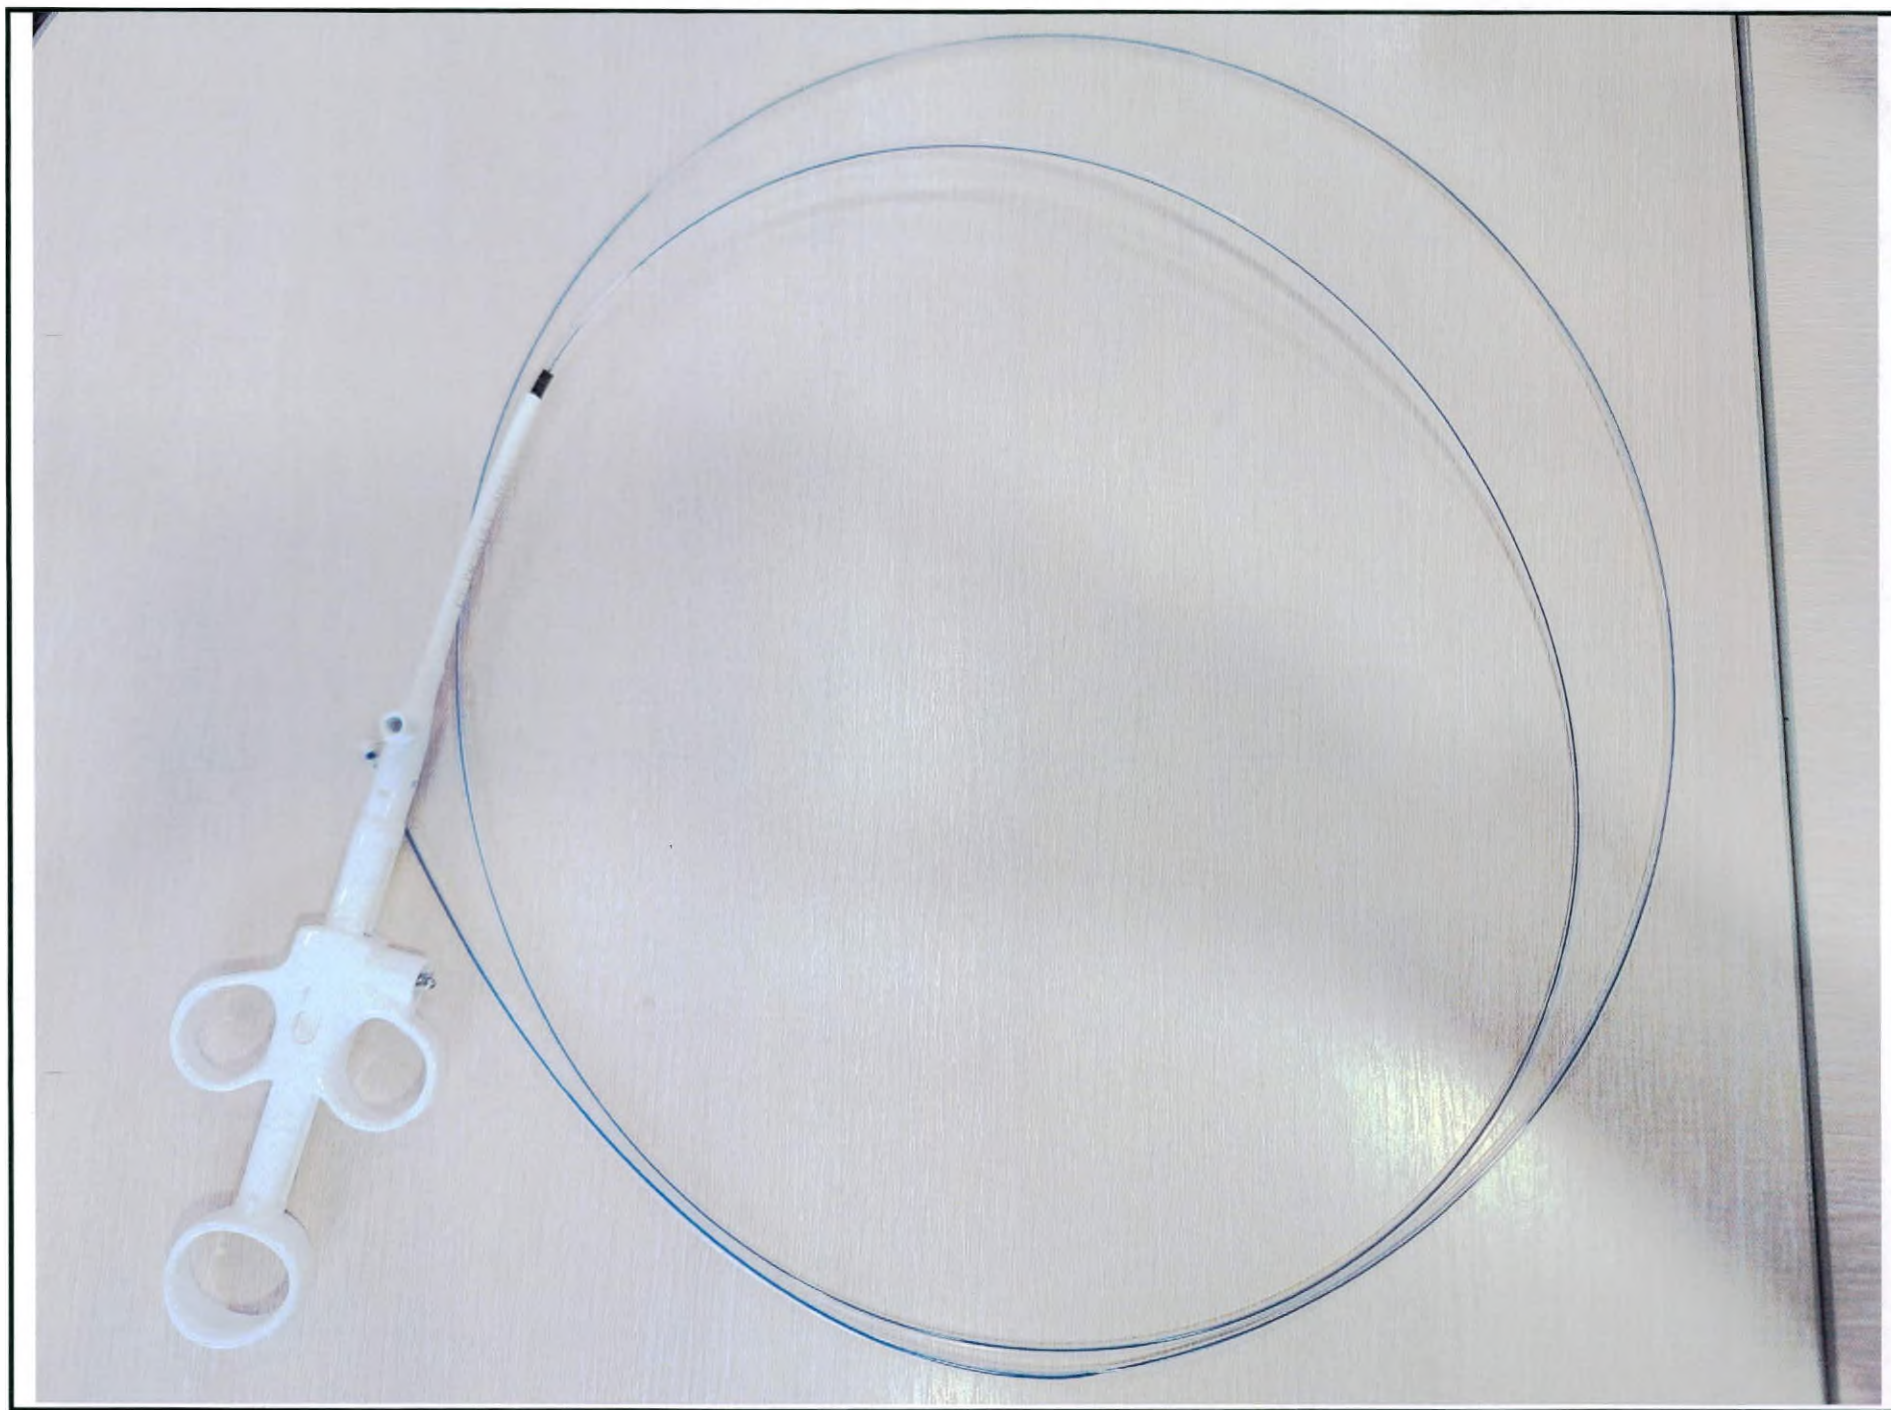

1. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N10- (1 шт./уп.) - (Игольчатый тип)

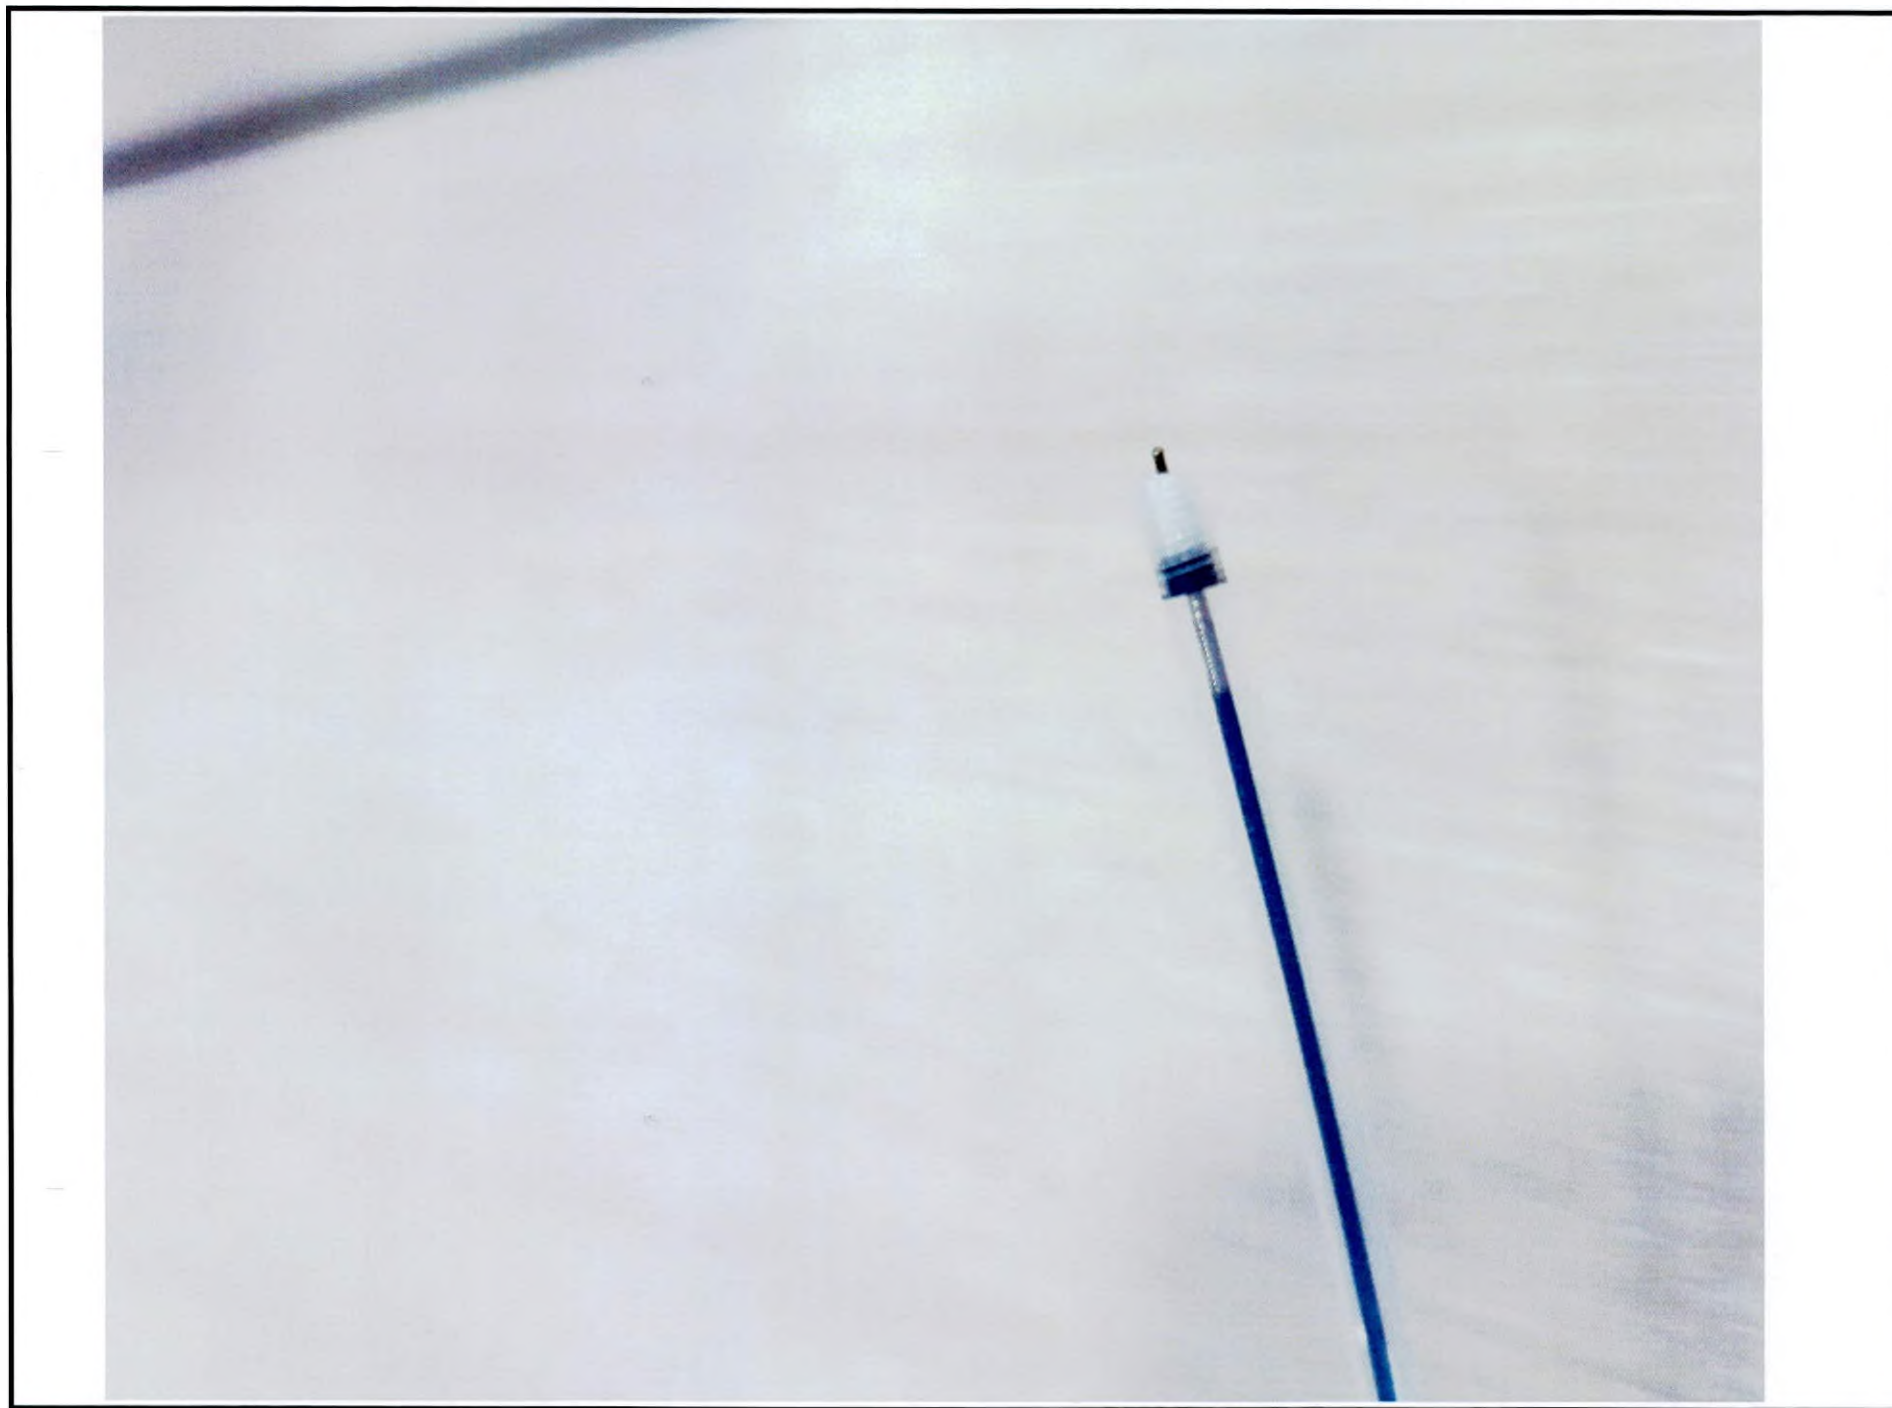


2. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N15- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)






DK2618J -N15-

Diathermic Slitter





en : Diathermic Slitter
 de : Diathermische Sonde
 fr : Couteau diathermique
 it : Bisturi diatermico
 es : Bisturi diatérmico
 pt : Cortador diatérmico
 nl : Diathermische snijmachine
 tr : Diyatermik Dilici



≥2.8mm



1800mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
 de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
 fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
 it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
 es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
 pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
 nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
 tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 1800mm
 de : Arbeitslänge : 1800mm
 fr : Longueur utile : 1800mm
 it : Lunghezza utile di lavoro : 1800mm
 es : Longitud de trabajo : 1800mm
 pt : Comprimento de trabalho : 1800mm
 nl : Werklengte : 1800mm
 tr : Çalışma uzunluğu : 1800mm








STERILE EO




CE 0123

2016-11

2013-12

LOT 1312A1

MADE IN JAPAN
1312A1






en : Stored in a package box
 de : In einer Produktverpackung aufbewahrt
 fr : Rangé dans une boîte d'emballage

it : Conservato in una scatola della confezione
 es : Almacenado en un embalaje
 pt : Guardado numa embalagem
 nl : Opgeslagen in een bewaardoos
 tr : Ambalajda saklı

2. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N15- (1 шт./уп.) - (общий вид упаковки)

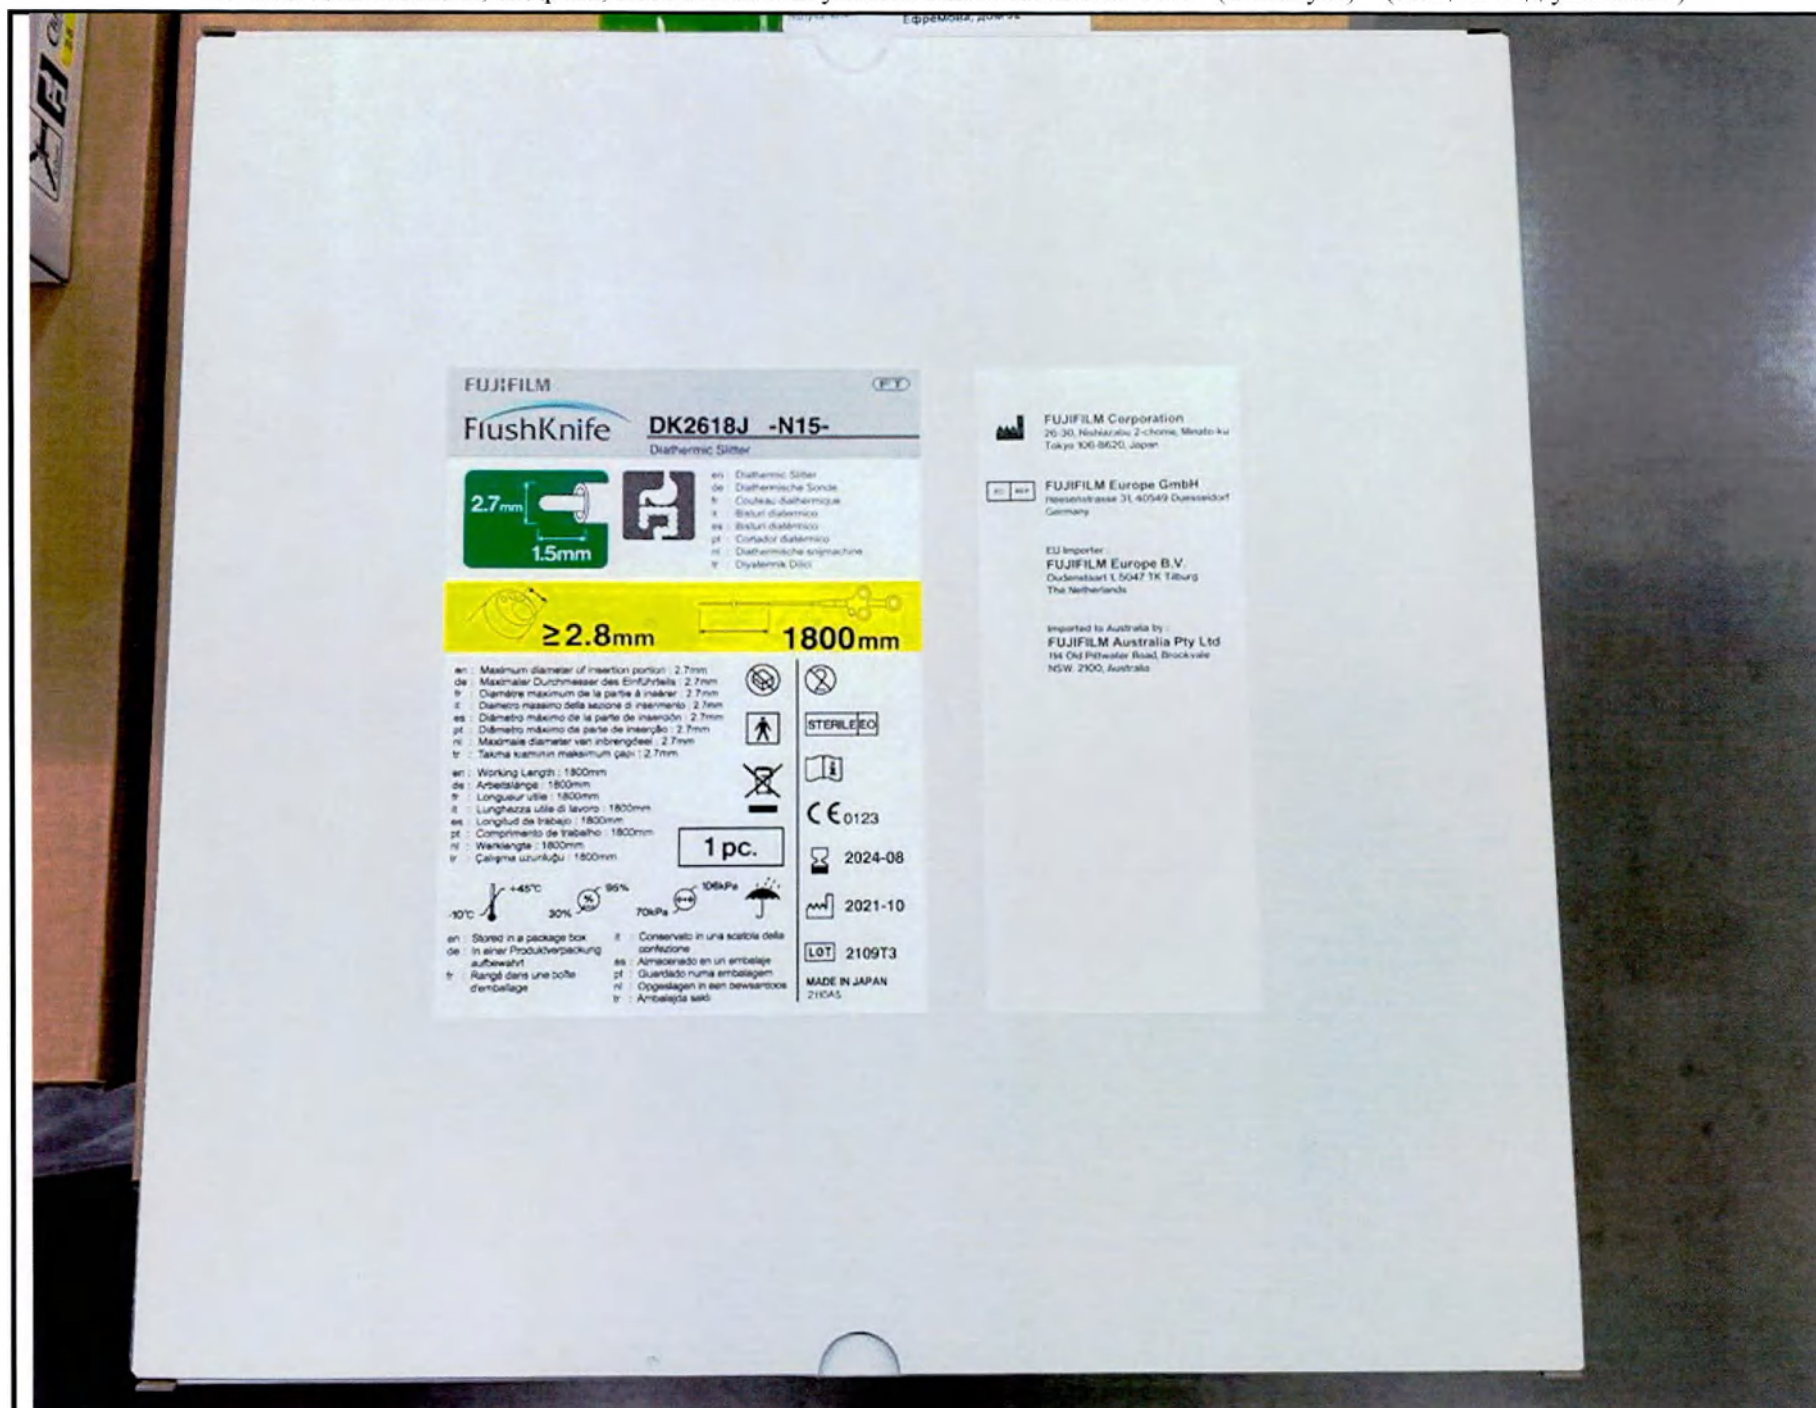

2. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N15- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)


FUJIFILM

FlushKnife

DK2618J -N15-

Diathermic Slitter

(FT)



2.7mm
1.5mm



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturi diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥2.8mm



1800mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 1800mm
de : Arbeitslänge : 1800mm
fr : Longueur utile : 1800mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 1800mm
es : Longitud de trabajo : 1800mm
pt : Comprimento de trabalho : 1800mm
nl : Werklength : 1800mm
tr : Çalışma uzunluğu : 1800mm









GS1-128



(01) 04547410324143 (17) 161100 (10) 1312A1

DK2618J -N15- FF828A P1-0

STERILE EO

CE 0123

2016-11

2013-12

LOT 1312A1


MADE IN JAPAN

1312A1


2. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N15- (1 шт./уп.) - стерильная упаковка



2. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N15- (1 шт./уп.)

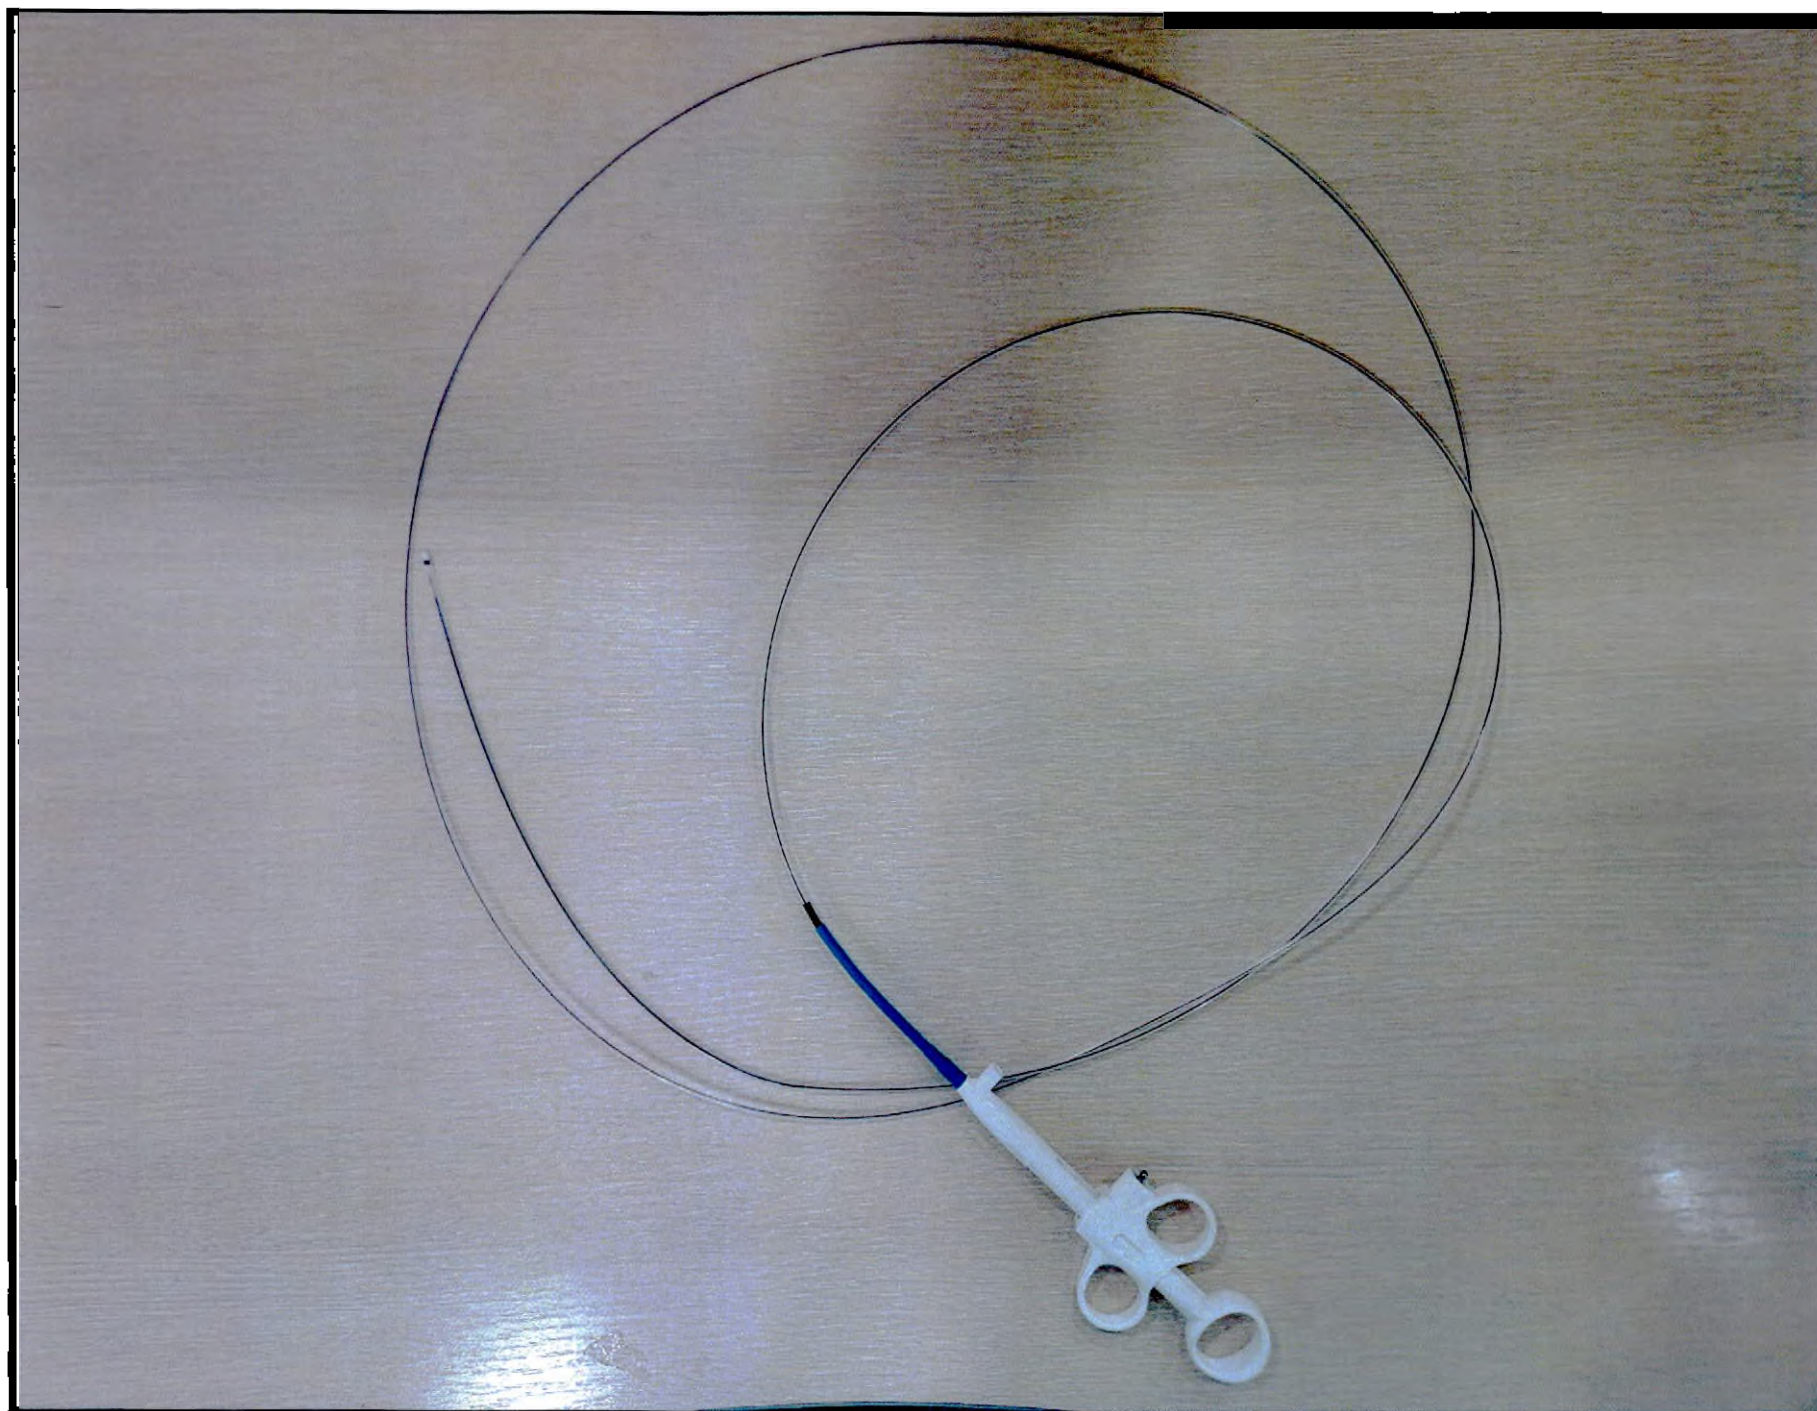


2. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N15- (1 шт./уп.) (Игольчатый тип)

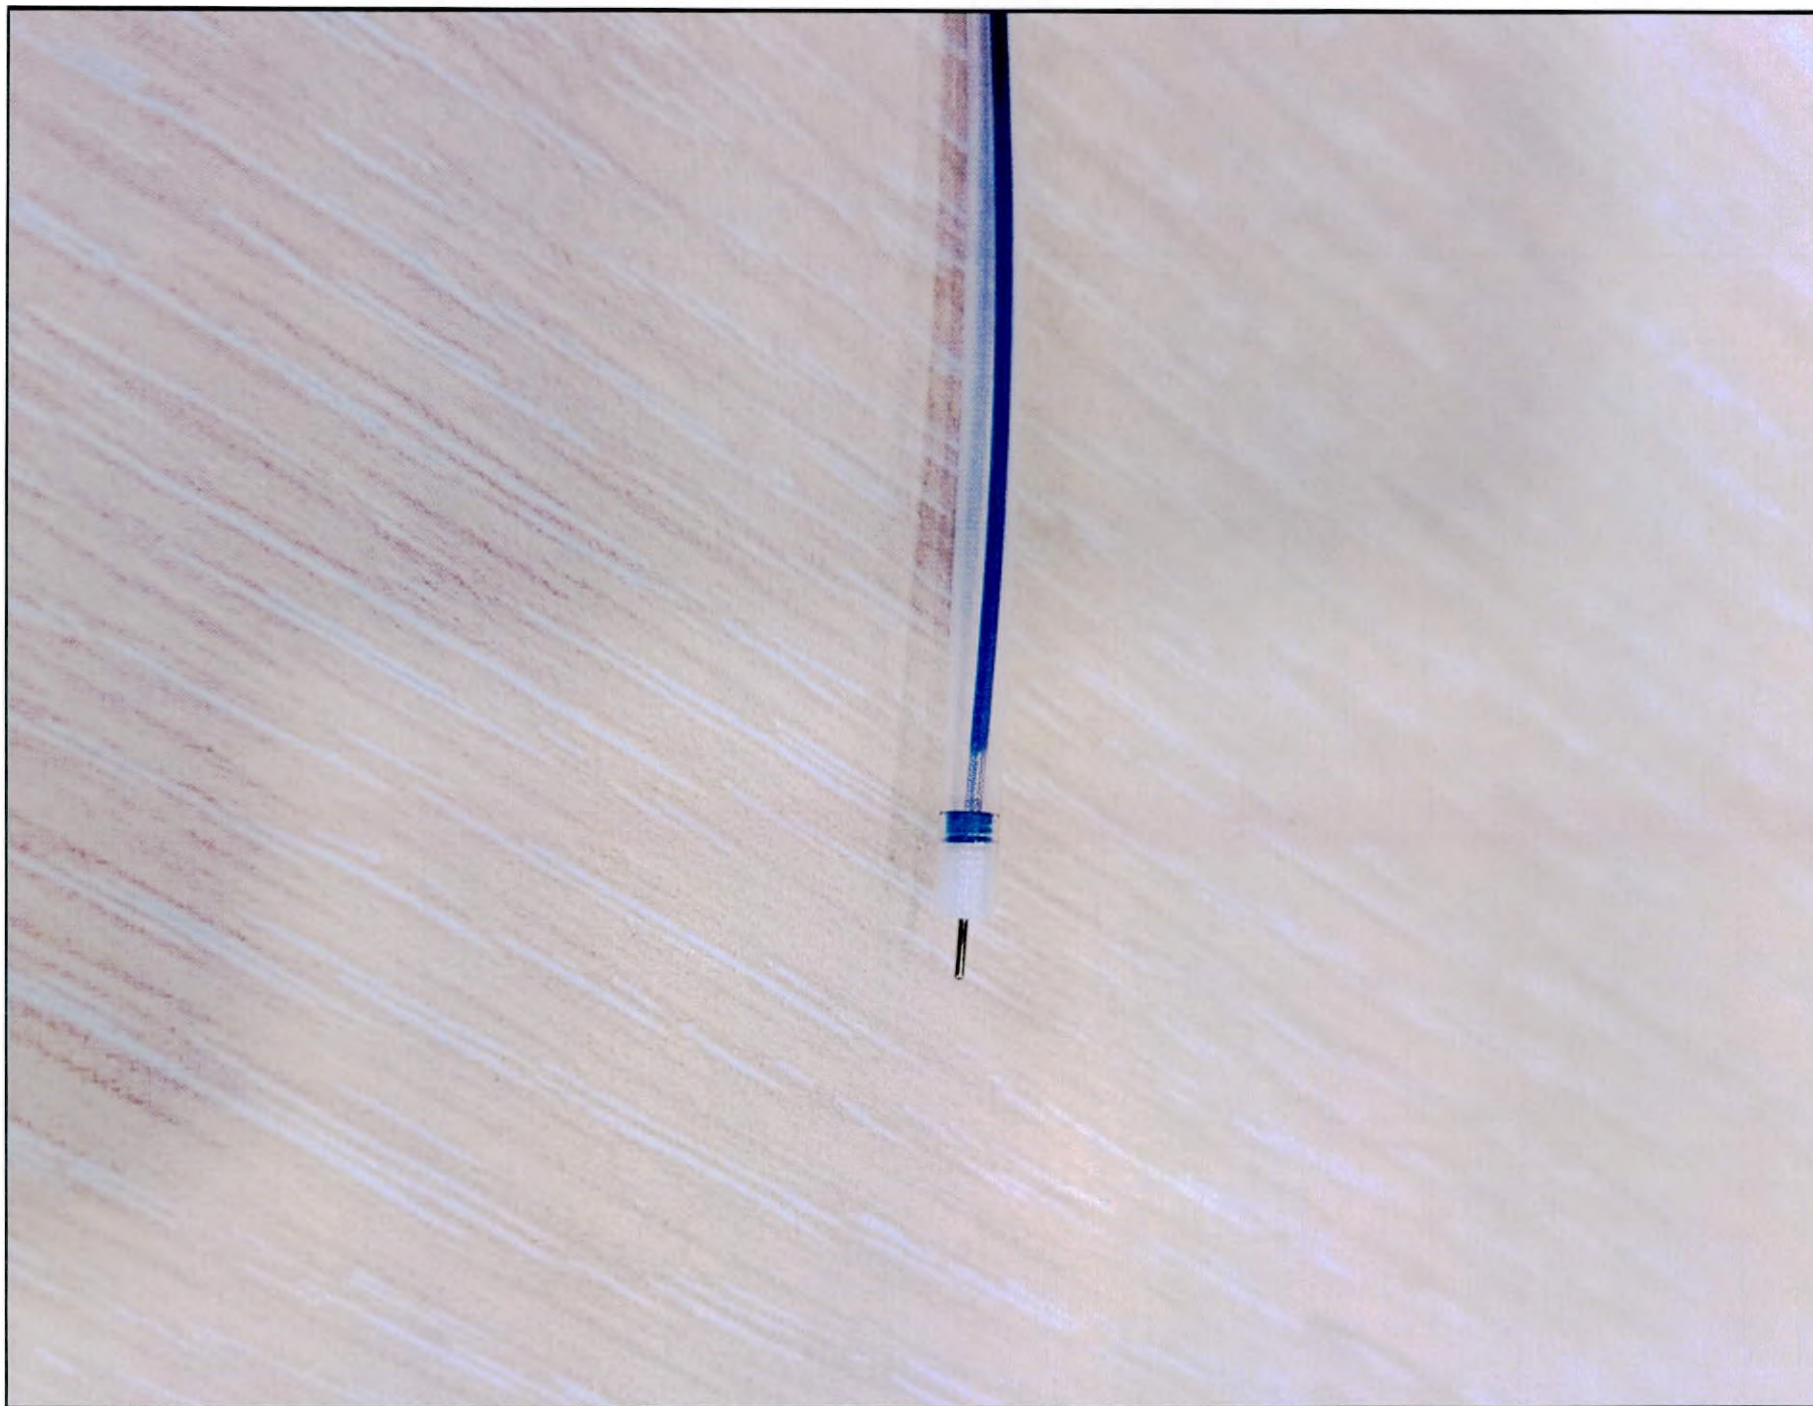

 ООО ЦИПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N25- (1 шт./уп.)
(общий вид упаковки/картонной коробки)

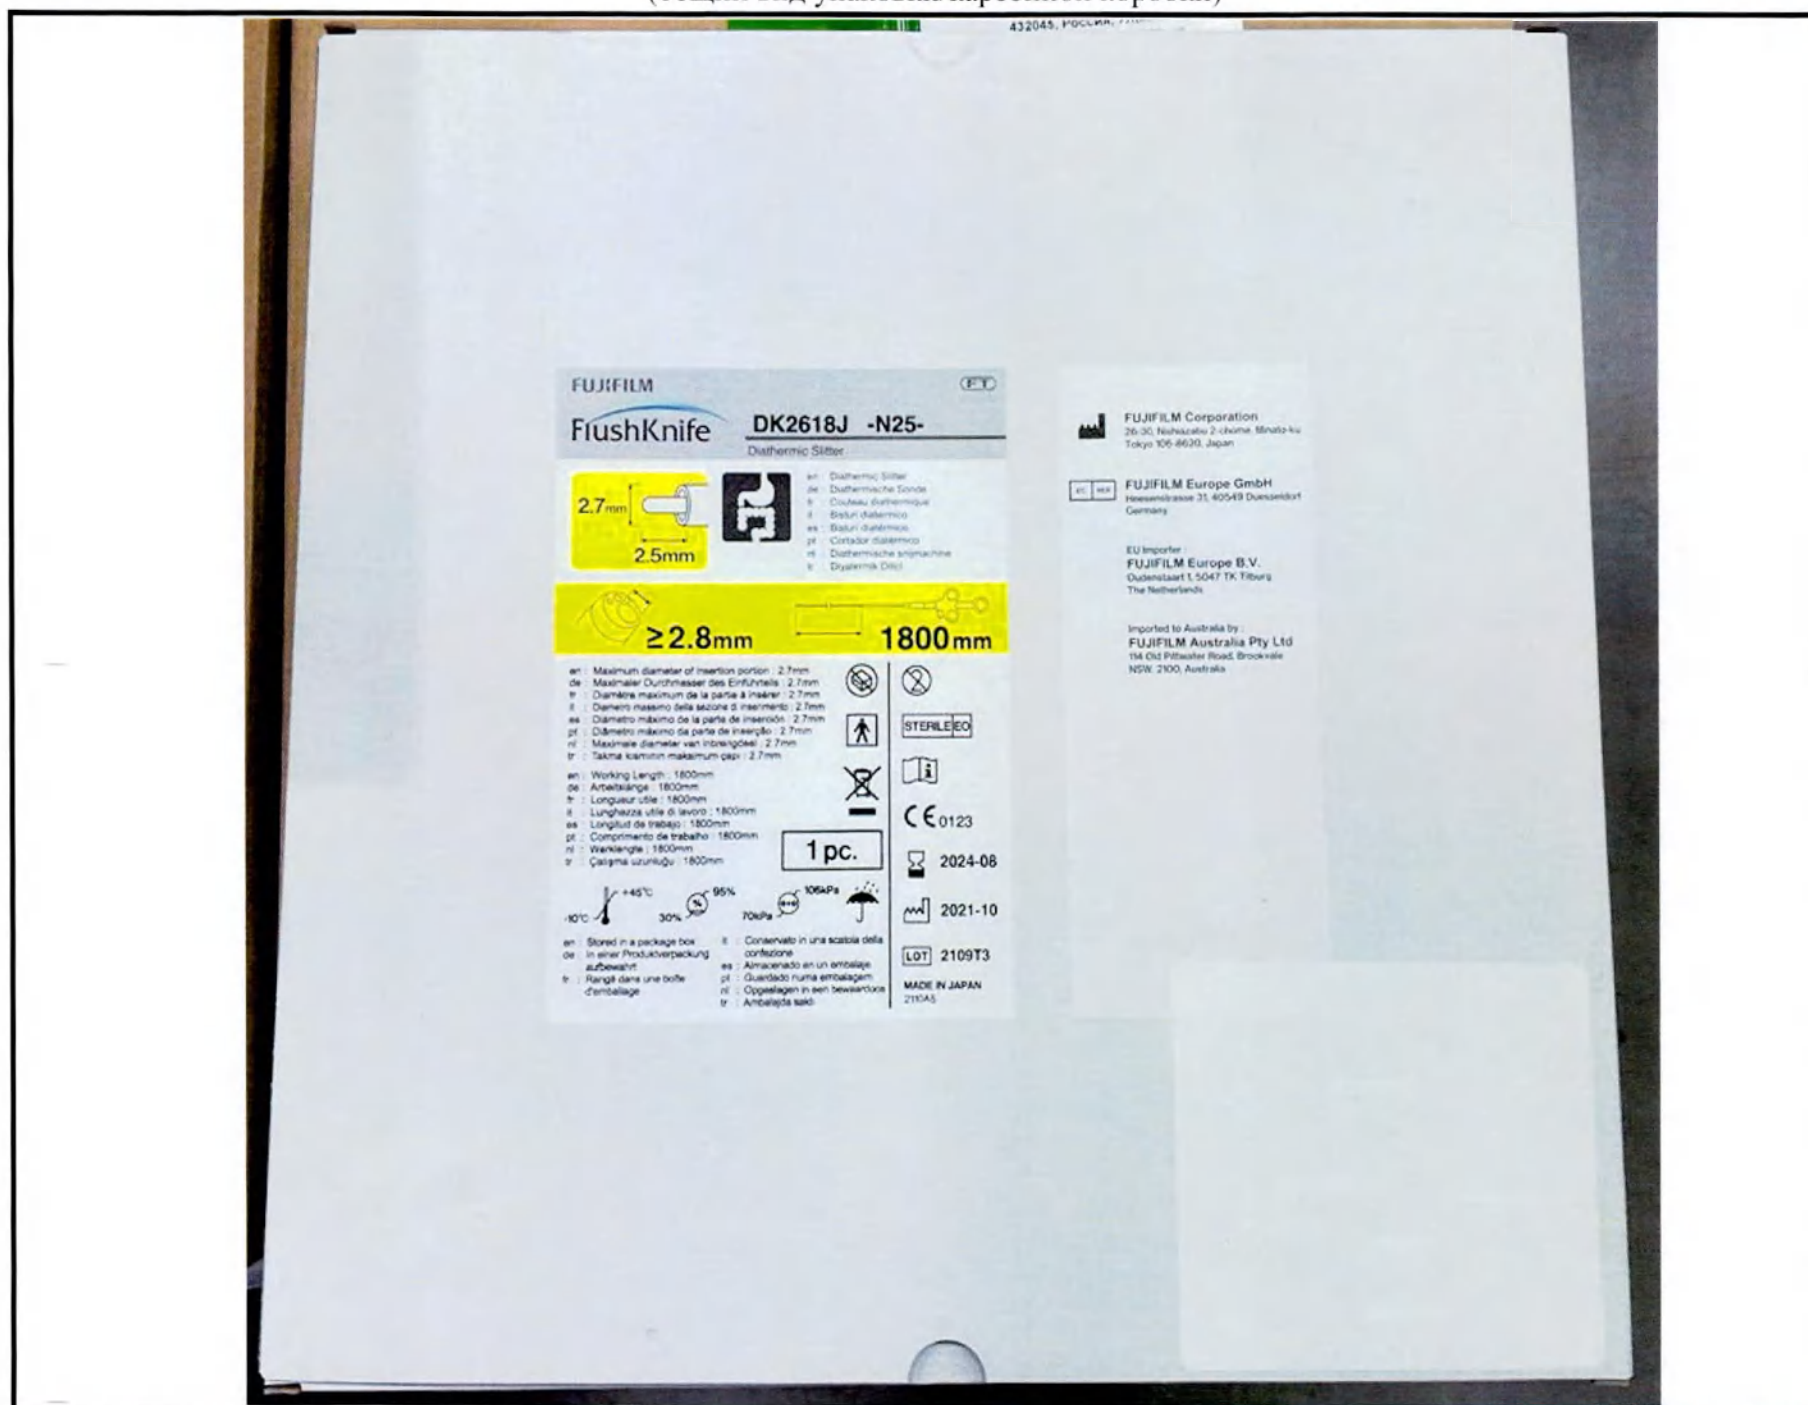

3. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N25- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)

FUJIFILM

FlushKnife

DK2618J -N25-

Diathermic Slitter

FT

2.7mm
2.5mm

en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici

≥2.8mm

1800mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 1800mm
de : Arbeitslänge : 1800mm
fr : Longueur utile : 1800mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 1800mm
es : Longitud de trabajo : 1800mm
pt : Comprimento de trabalho : 1800mm
nl : Werklengte : 1800mm
tr : Çalışma uzunluğu : 1800mm

STERILE

CE 0123

2016-11

2013-12

LOT 1312A1

MADE IN JAPAN

1312A1


GS1-128

(01) 04647410324167 (17) 161100 (10) 1312A1
DK2618J -N25- FF830A PT-0


3. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N25- (1 шт./уп.) - стерильная упаковка



3. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N25- (1 шт./уп.)

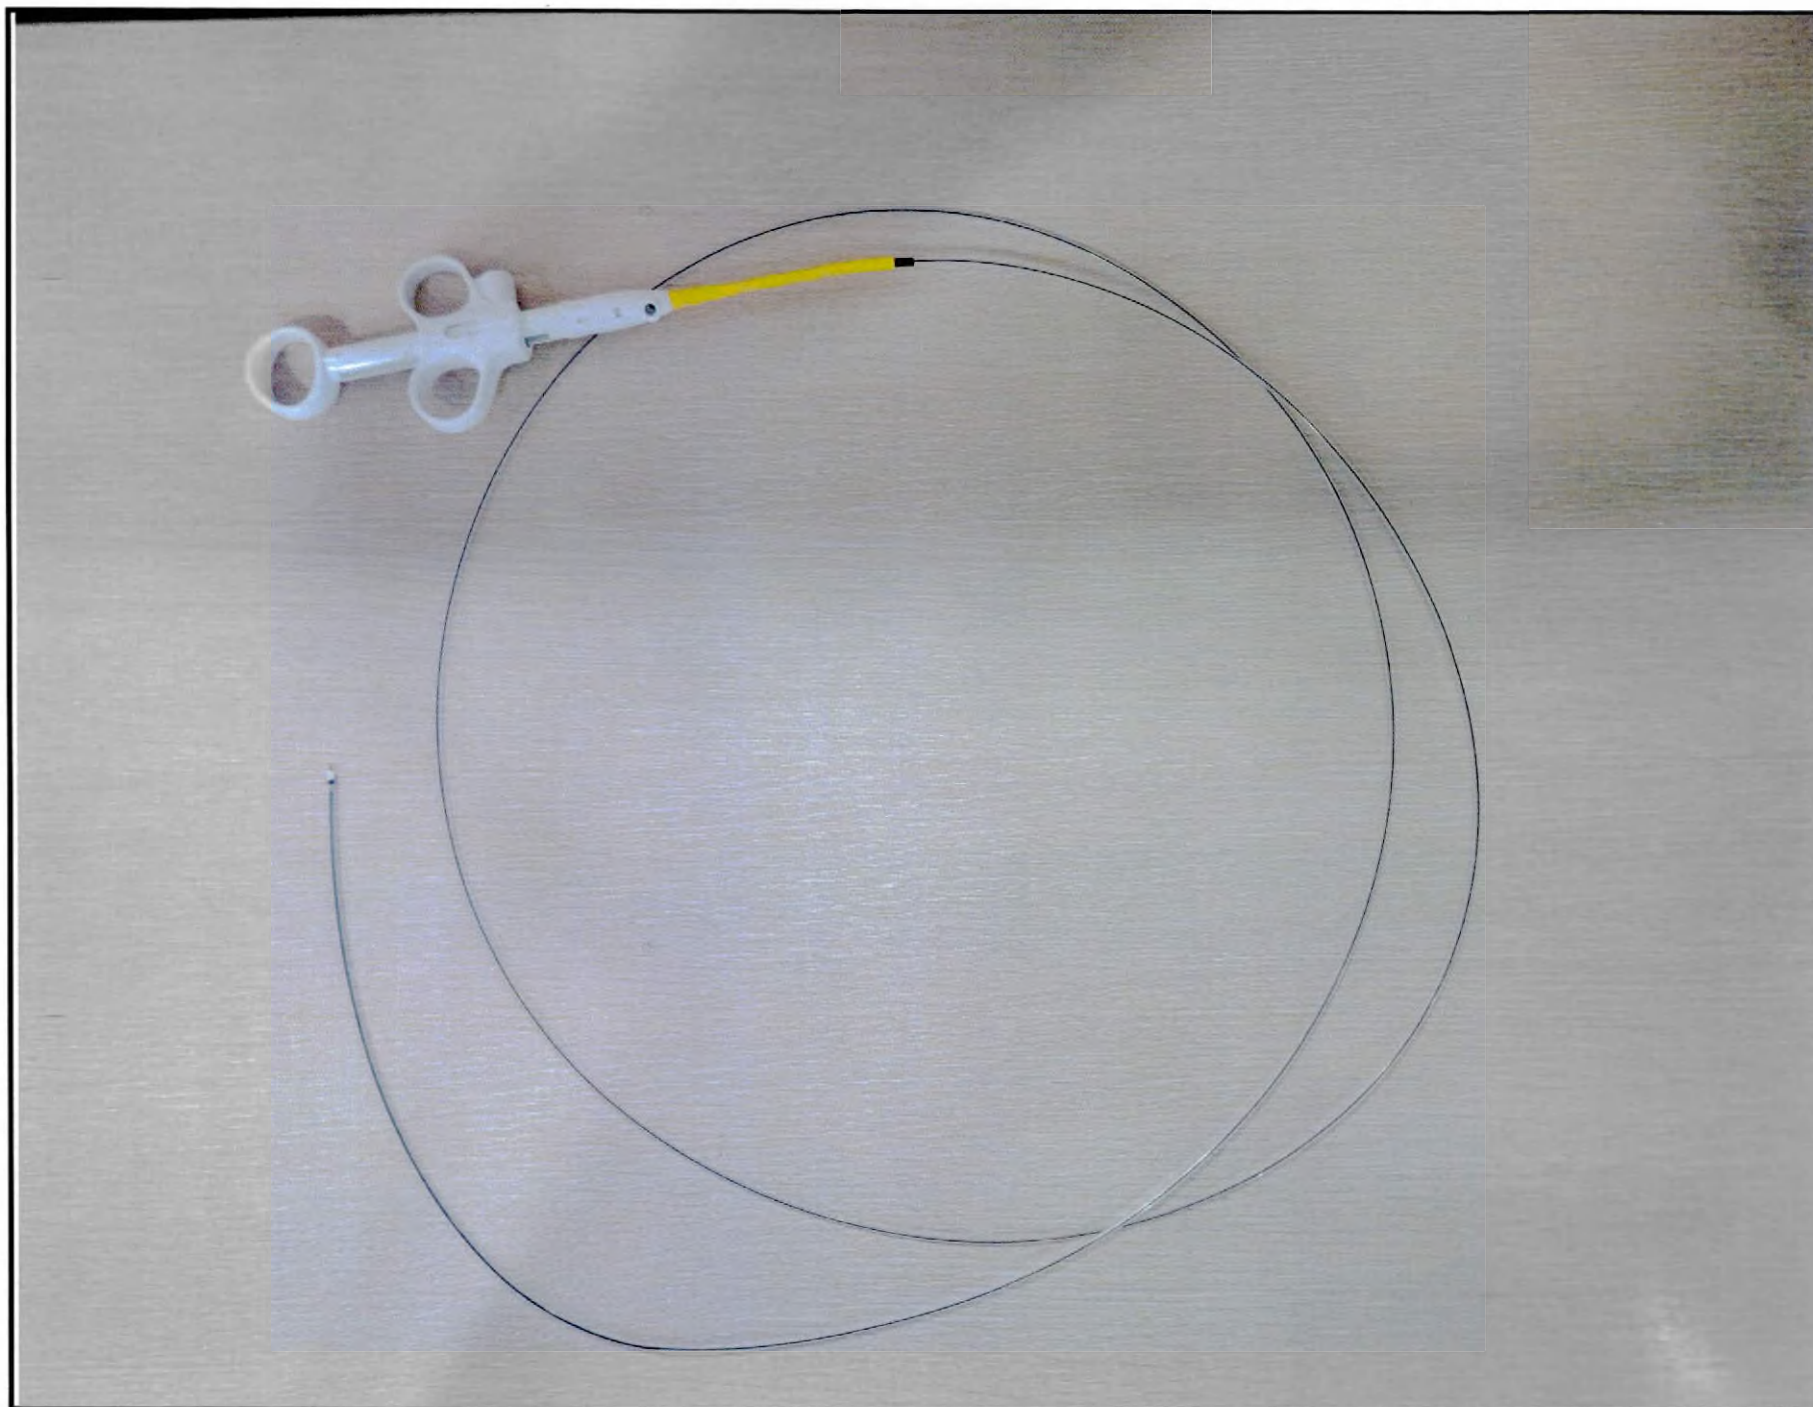

3. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N25- (1 шт./уп.) (Игольчатый тип)

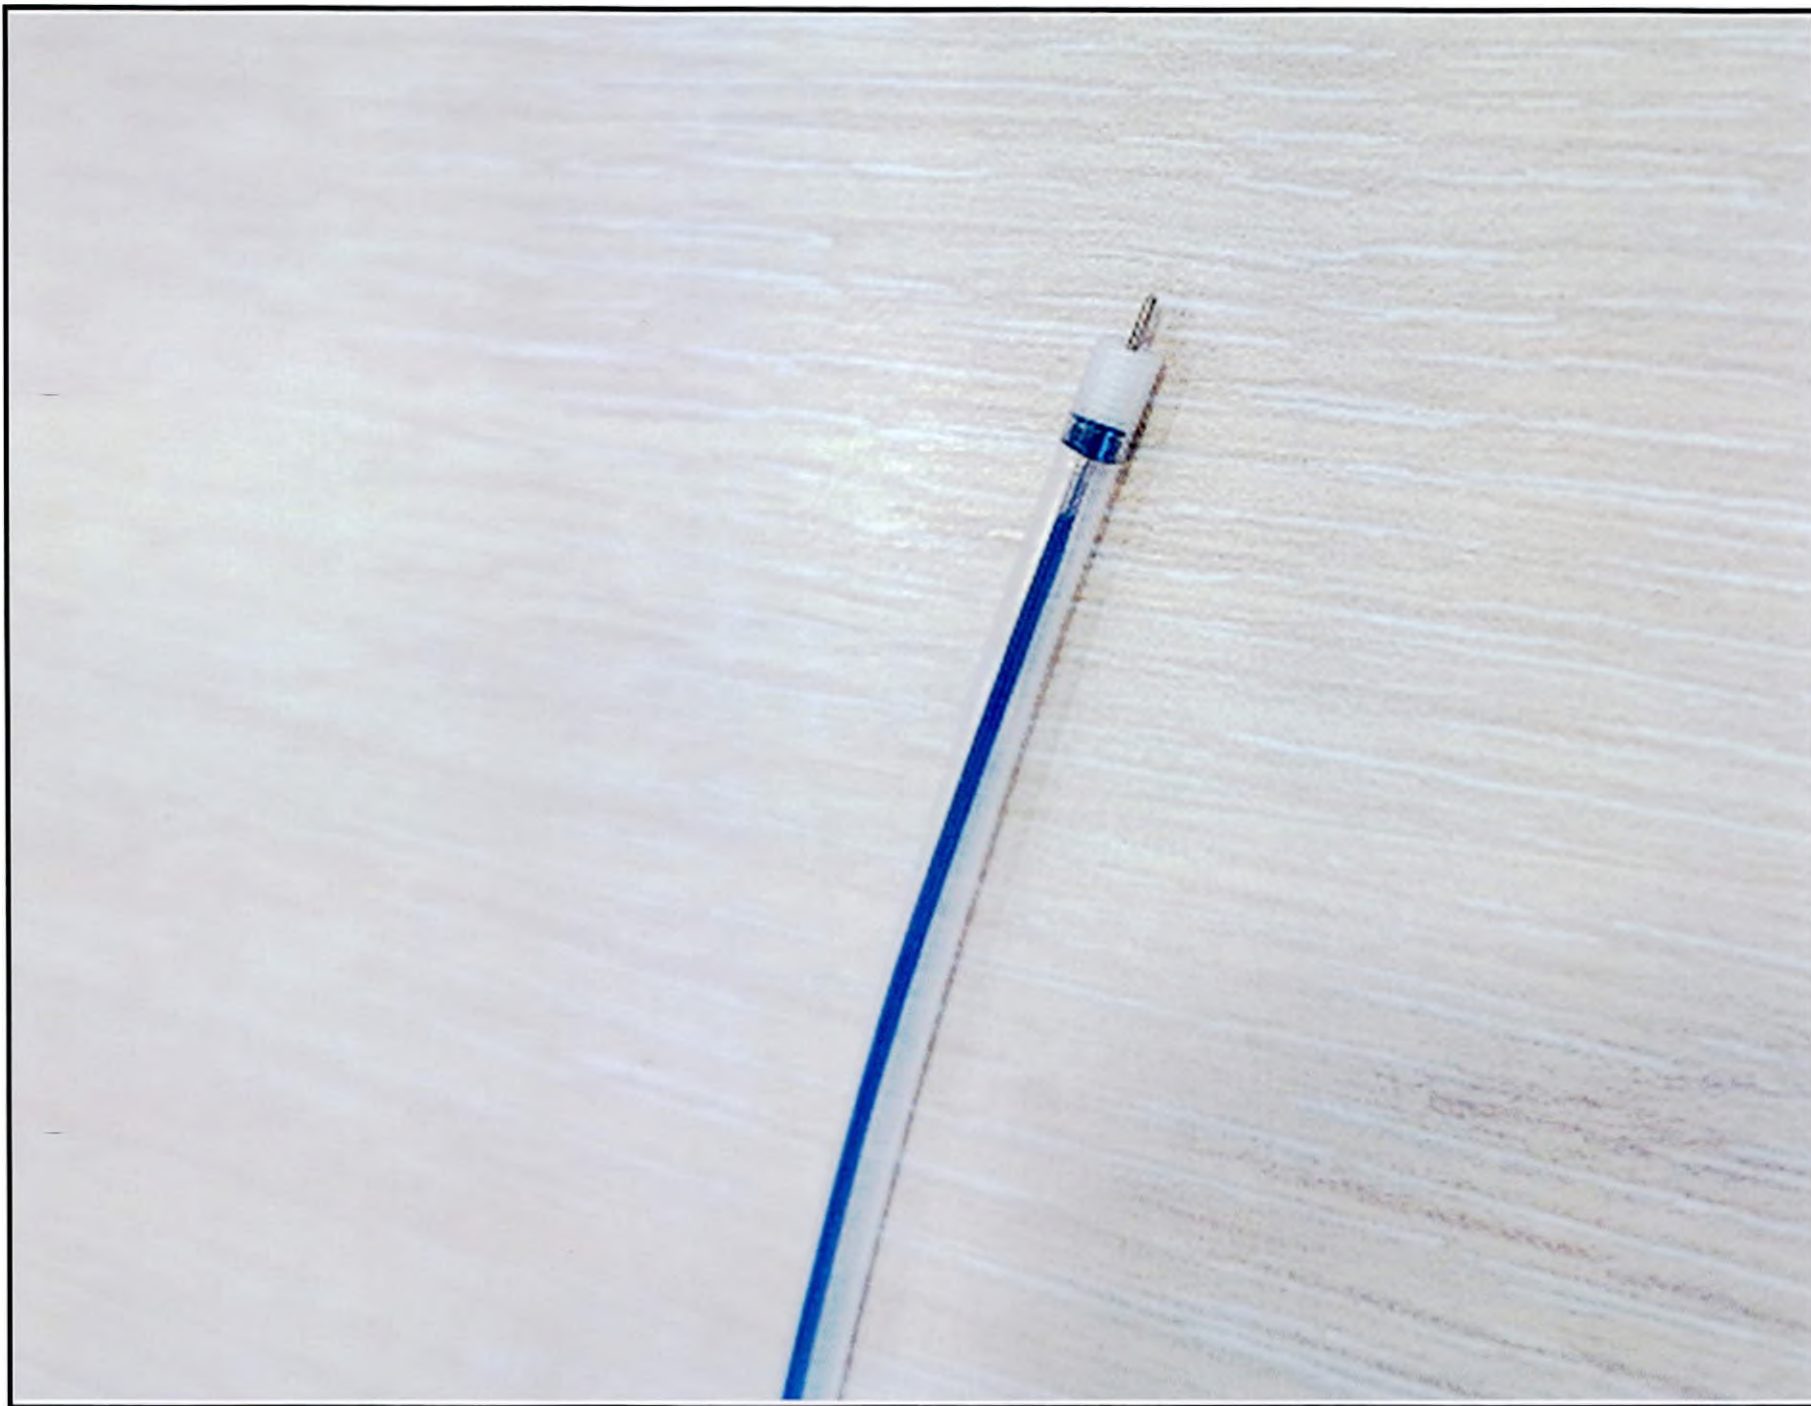


4. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N30- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)




FlushKnife

DK2618J -N30-

Diathermic Slitter






en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturi diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilci



≥2.8mm



1800mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 1800mm
de : Arbeitslänge : 1800mm
fr : Longueur utile : 1800mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 1800mm
es : Longitud de trabajo : 1800mm
pt : Comprimento de trabalho : 1800mm
nl : Werklength : 1800mm
tr : Çalışma uzunluğu : 1800mm














1 pc.



-10°C +45°C



30% 95%



70kPa 106kPa



en : Stored in a package box
de : In einer Produktverpackung aufbewahrt
fr : Rangé dans une boîte d'emballage

it : Conservato in una scatola della confezione
es : Almacenado en un embalaje
pt : Guardado numa embalagem
nl : Opgeslagen in een bewaardoos
tr : Ambalajda saklı



STERILE EO





0123



2016-11



2013-12




1312A1

MADE IN JAPAN

1312A1

4. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N30- (1 шт./уп.) - - (общий вид упаковки/картонной коробки)

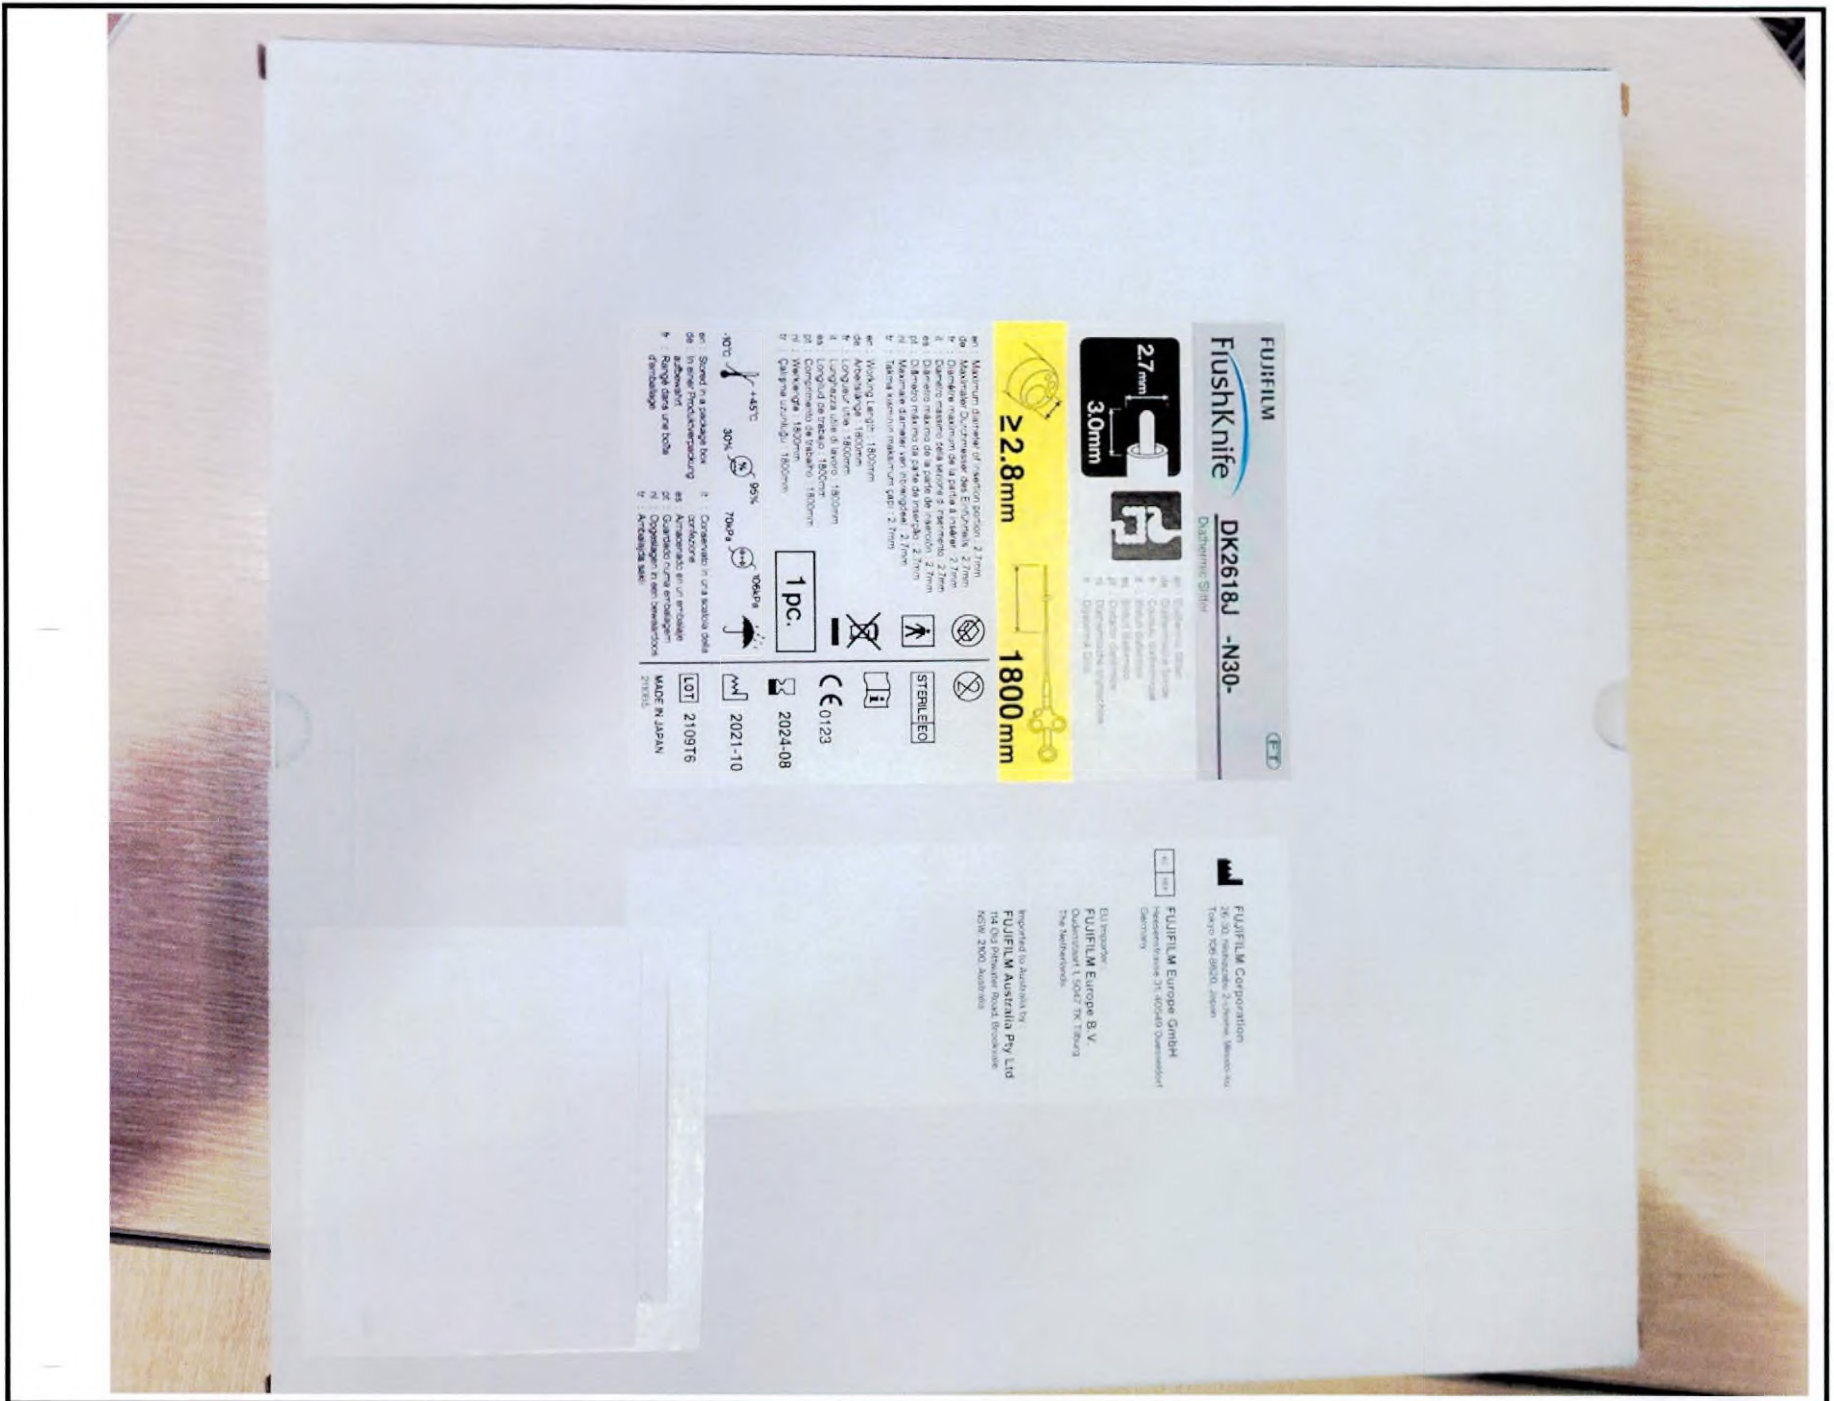


4. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N30- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)




FlushKnife

DK2618J -N30-

Diathermic Slitter



2.7mm
3.0mm



≥2.8mm
1800mm

en : Diathermic Slitter
 de : Diathermische Sonde
 fr : Couteau diathermique
 it : Bisturi diatermico
 es : Bisturí diatérmico
 pt : Cortador diatérmico
 nl : Diathermische snijmachine
 tr : Diyatermik Dilici

en : Maximum diameter of Insertion portion : 2.7mm
 de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
 fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
 it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
 es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
 pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
 nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
 tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 1800mm
 de : Arbeitslänge : 1800mm
 fr : Longueur utile : 1800mm
 it : Lunghezza utile di lavoro : 1800mm
 es : Longitud de trabajo : 1800mm
 pt : Comprimento de trabalho : 1800mm
 nl : Werklength : 1800mm
 tr : Çalışma uzunluğu : 1800mm











GS1-128



(01) 04547410324174 (17) 161100 (10) 1312A1
 DK2618J -N30- FF831A PI-0

STERILE EO

 0123

 2016-11

 2013-12


LOT 1312A1

MADE IN JAPAN
 1312A1


4. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N30- (1 шт./уп.) - стерильная упаковка



4. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N30- (1 шт./уп.)

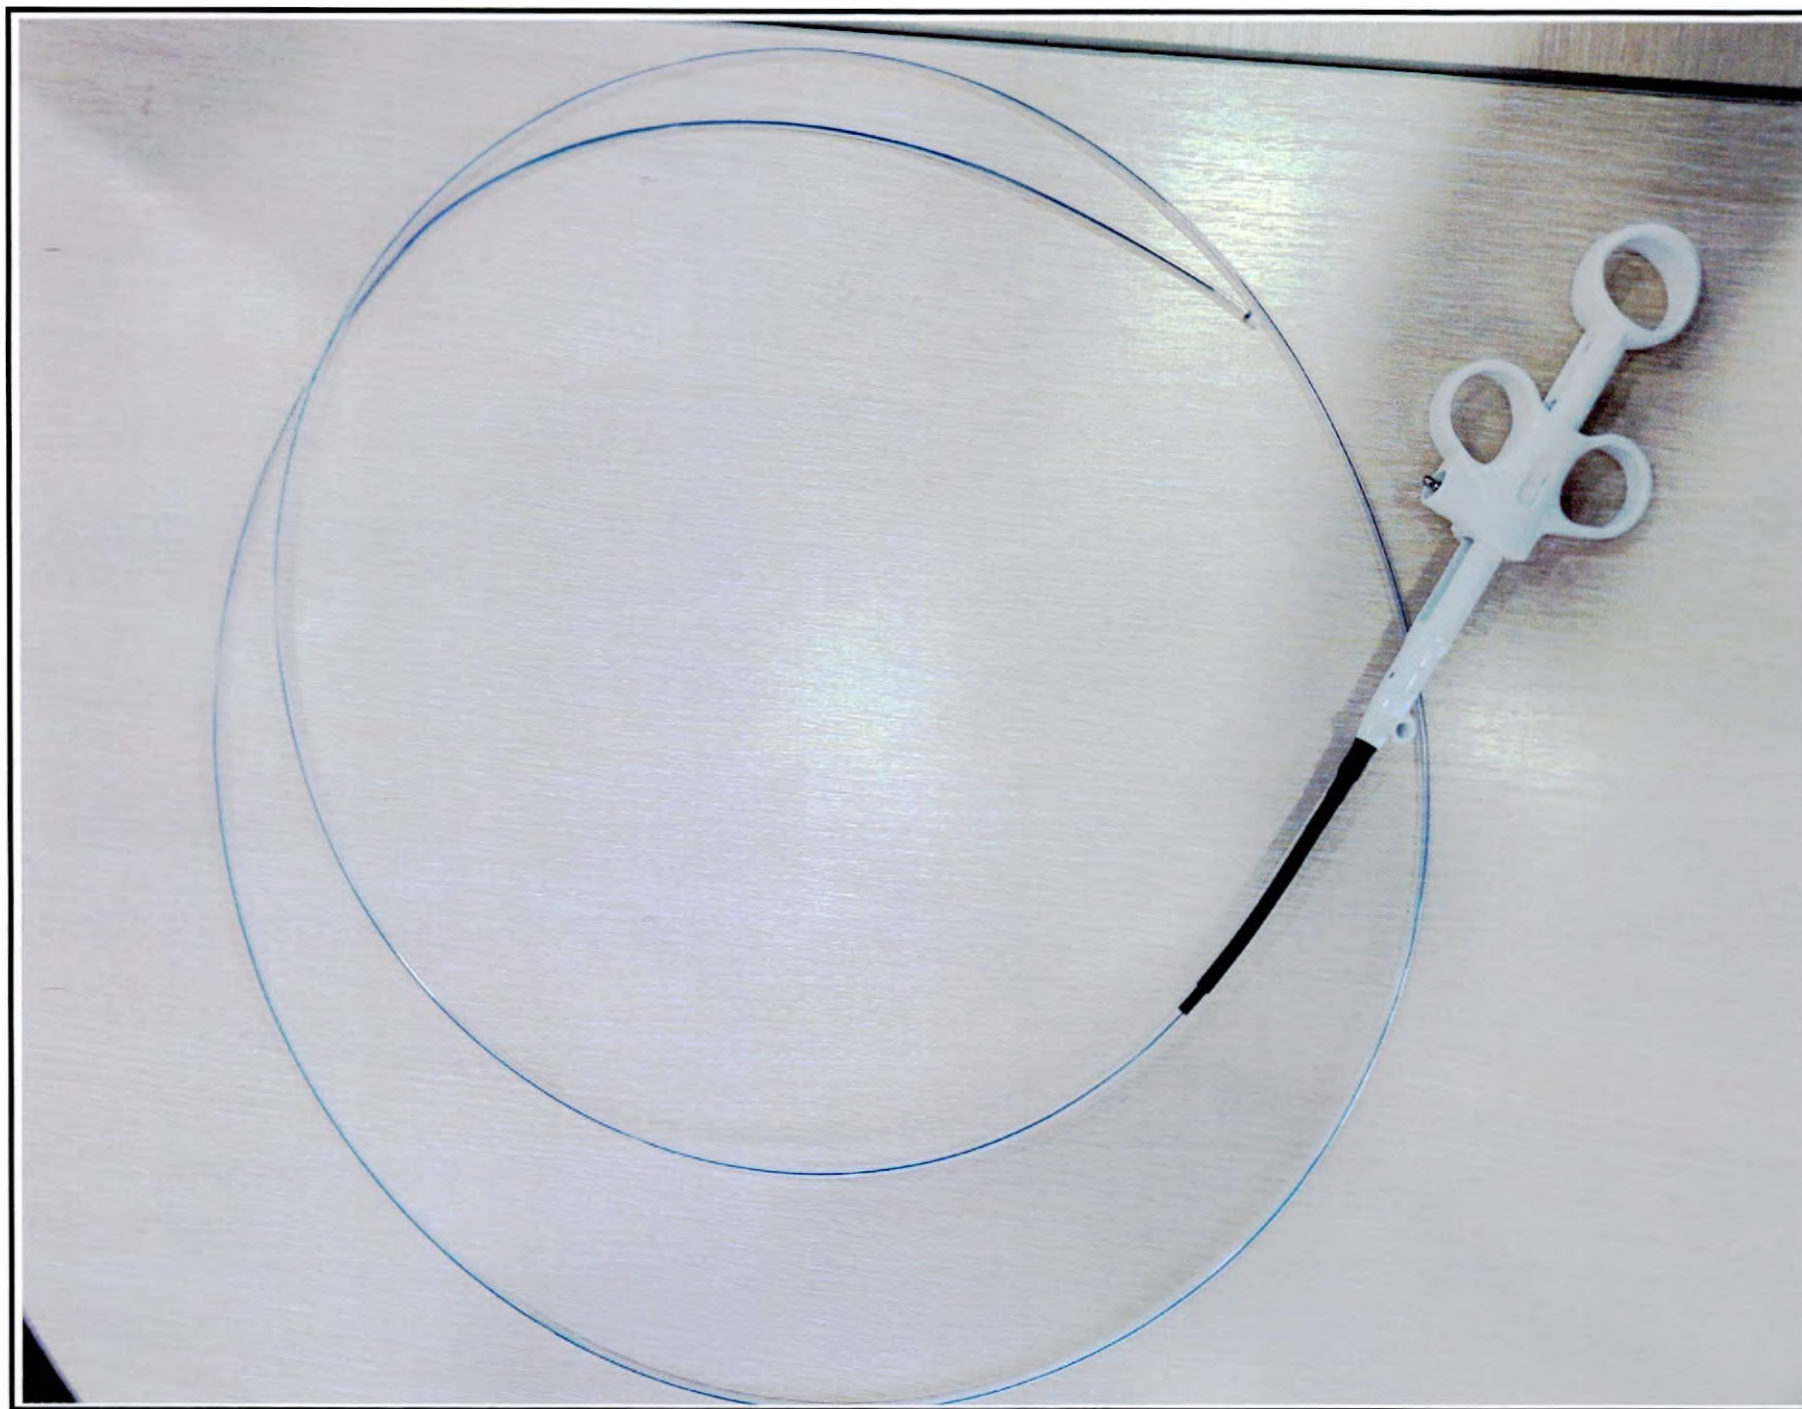

4. Пож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2618J-N30- (1 шт./уп.) (Игольчатый тип)

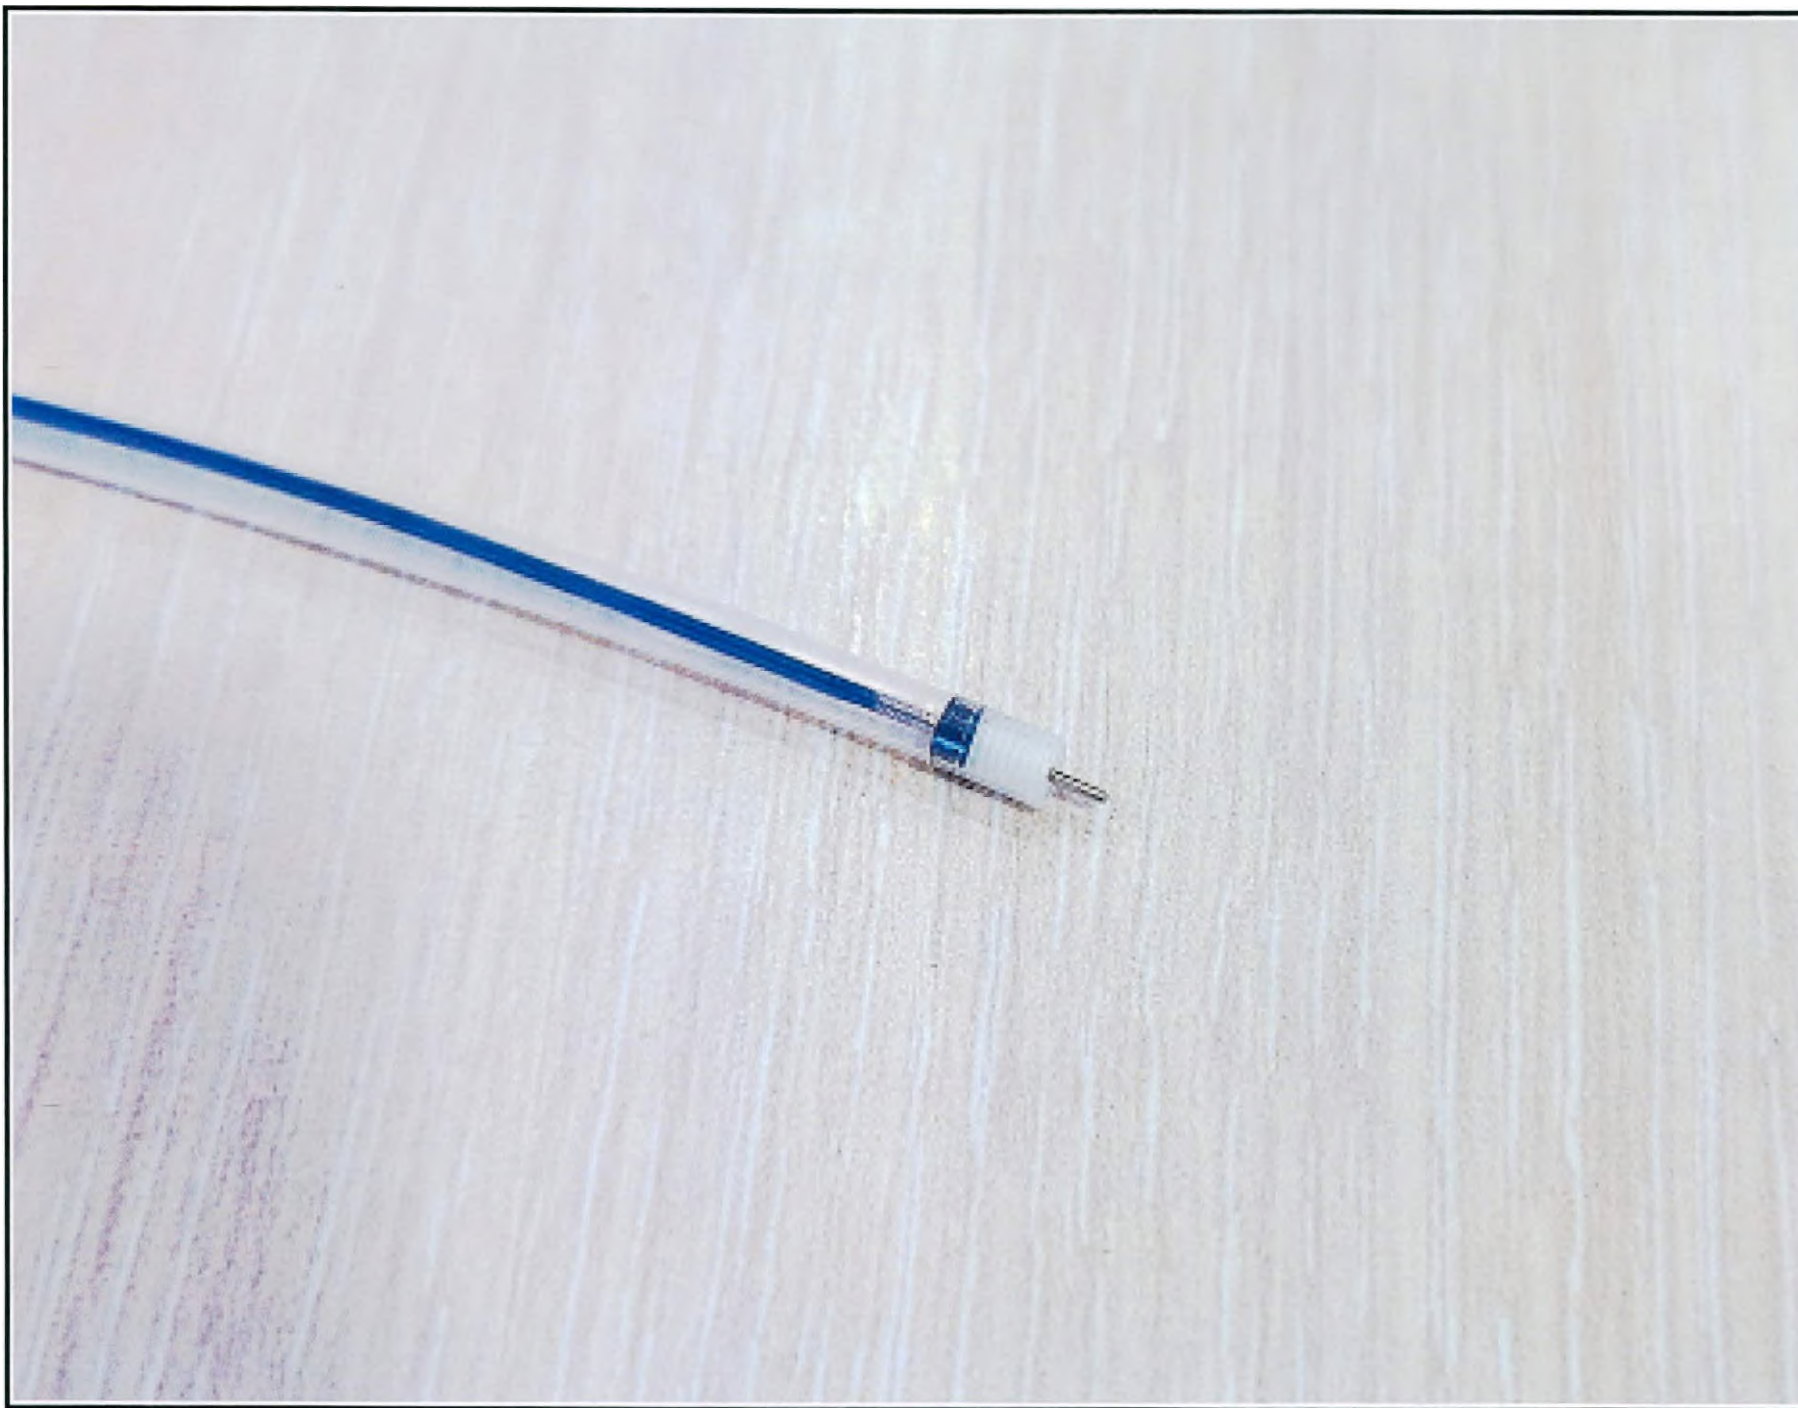

5. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2618J-B20- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)


FUJIFILM

(FT)


FlushKnife BT

DK2618J -B20-

Diathermic Slitter



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici

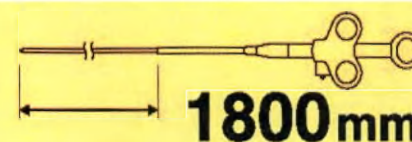

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 1800mm
de : Arbeitslänge : 1800mm
fr : Longueur utile : 1800mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 1800mm
es : Longitud de trabajo : 1800mm
pt : Comprimento de trabalho : 1800mm
nl : Werklengte : 1800mm
tr : Çalışma uzunluğu : 1800mm



1 pc.



STERILE EO



CE 0123



2016-11




2013-12

LOT

1312A1

MADE IN JAPAN


1312A1



en : Stored in a package box
de : In einer Produktverpackung
aufbewahrt
fr : Rangé dans une boîte
d'emballage

it : Conservato in una scatola della
confezione
es : Almacenado en un embalaje
pt : Guardado numa embalagem
nl : Opgeslagen in een bewaardoos
tr : Ambalajda saklı

5. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения DK2618J-B20-
(1 шт./уп.) - (общий вид упаковки/картонной коробки)

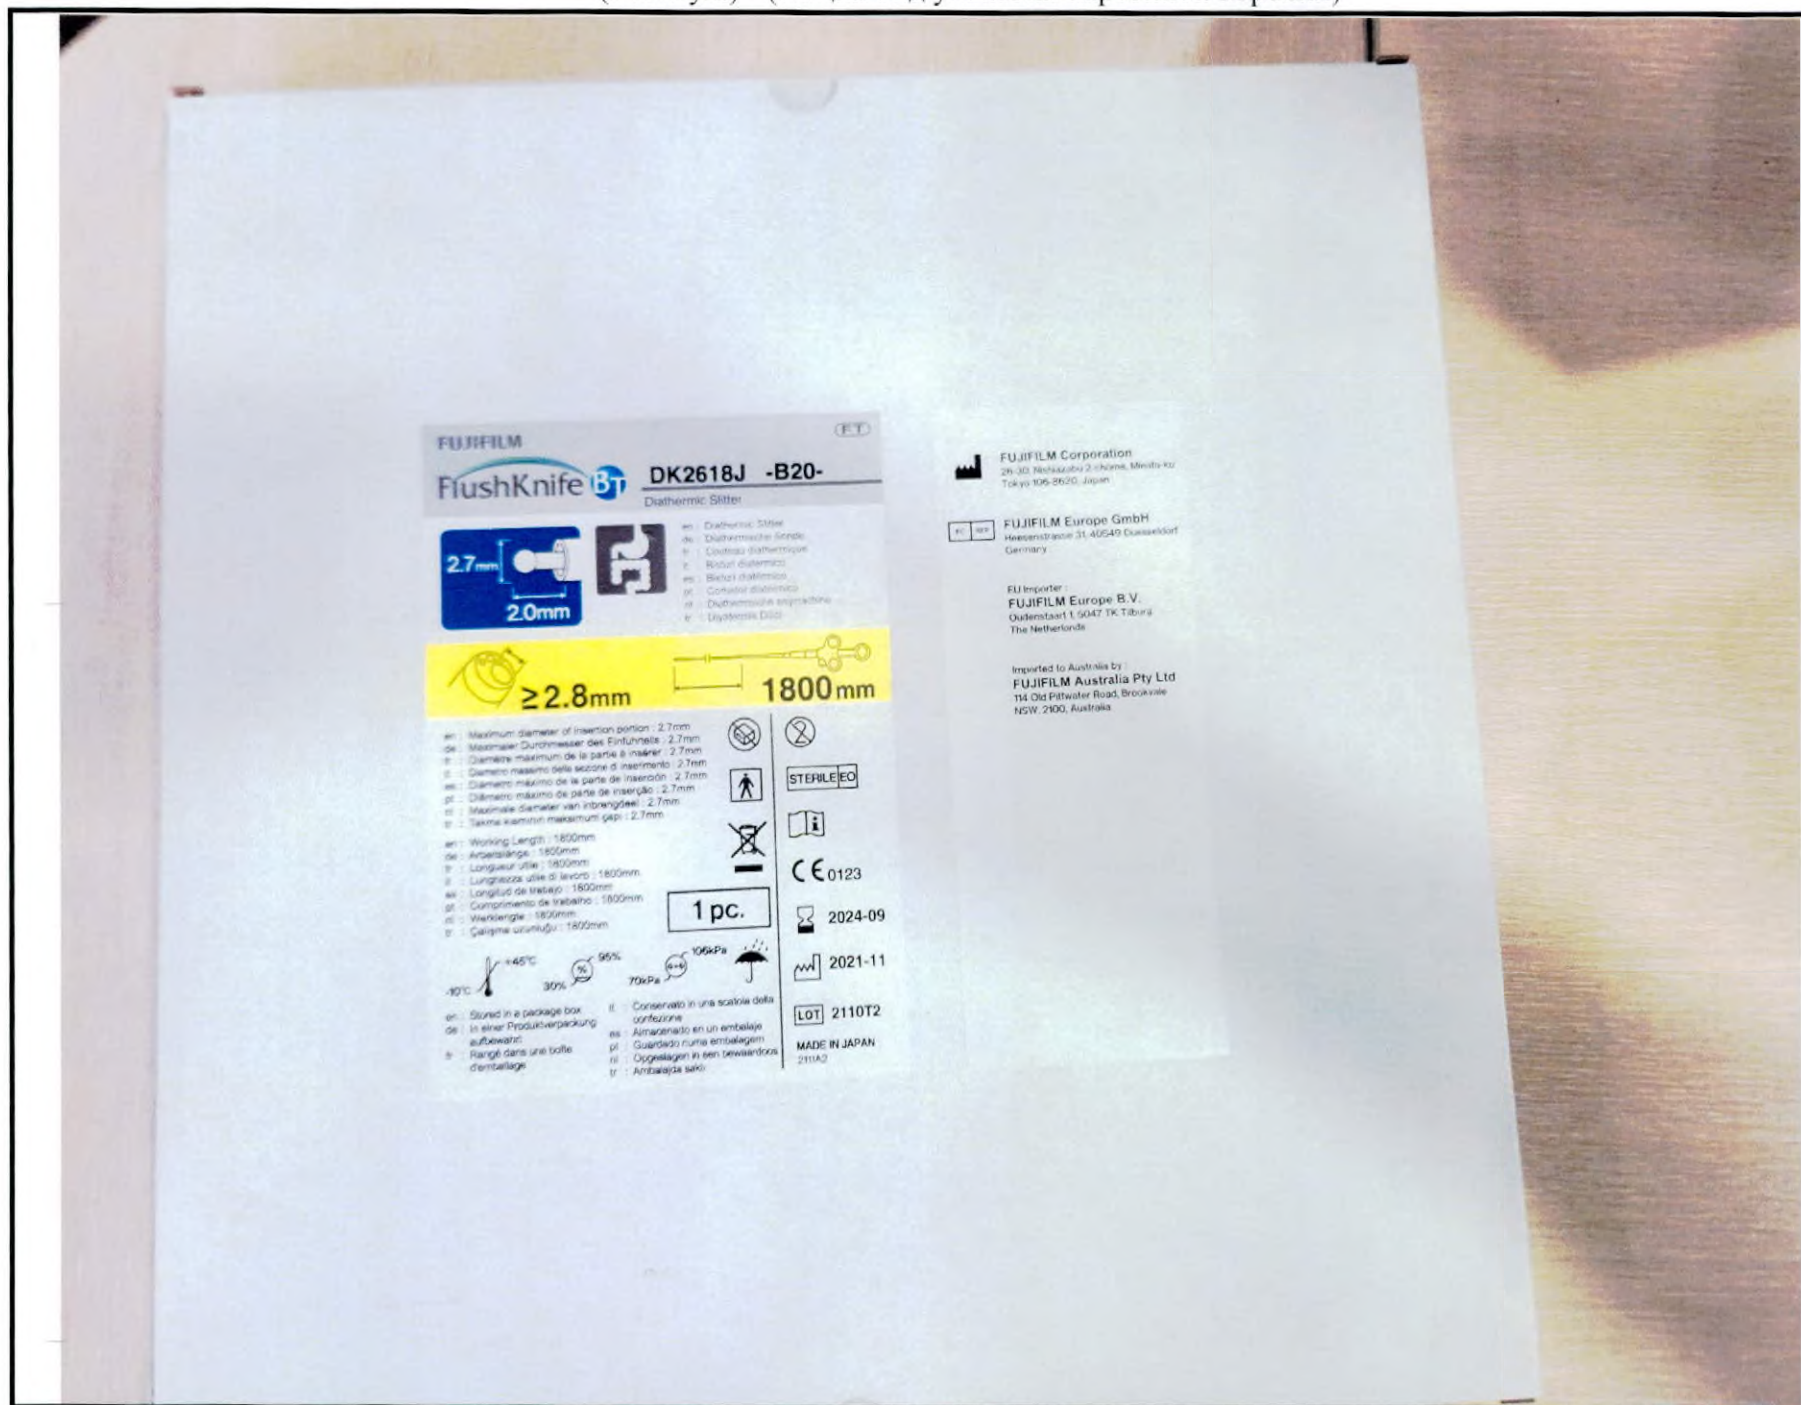


5. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2618J-B20- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)

FUJIFILM


FT

FlushKnife BT DK2618J -B20-

Diathermic Slitter



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici

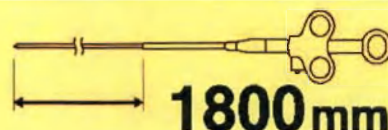

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 1800mm
de : Arbeitslänge : 1800mm
fr : Longueur utile : 1800mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 1800mm
es : Longitud de trabajo : 1800mm
pt : Comprimento de trabalho : 1800mm
nl : Werklengte : 1800mm
tr : Çalışma uzunluğu : 1800mm



STERILE EO



CE 0123

2016-11

2013-12

LOT 1312A1

MADE IN JAPAN
1312A1

GS1-128




(01) 04547410324105 (17) 161100 (10) 1312A1
DK2618J -B20- FF833A PI-0


5. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, аульсии ткани, остановки кровотечения
DK2618J-B20- (1 шт./уп.) - стерильная упаковка



5. Нож для абляции, подреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2618J-B20- (1 шт./уп.)

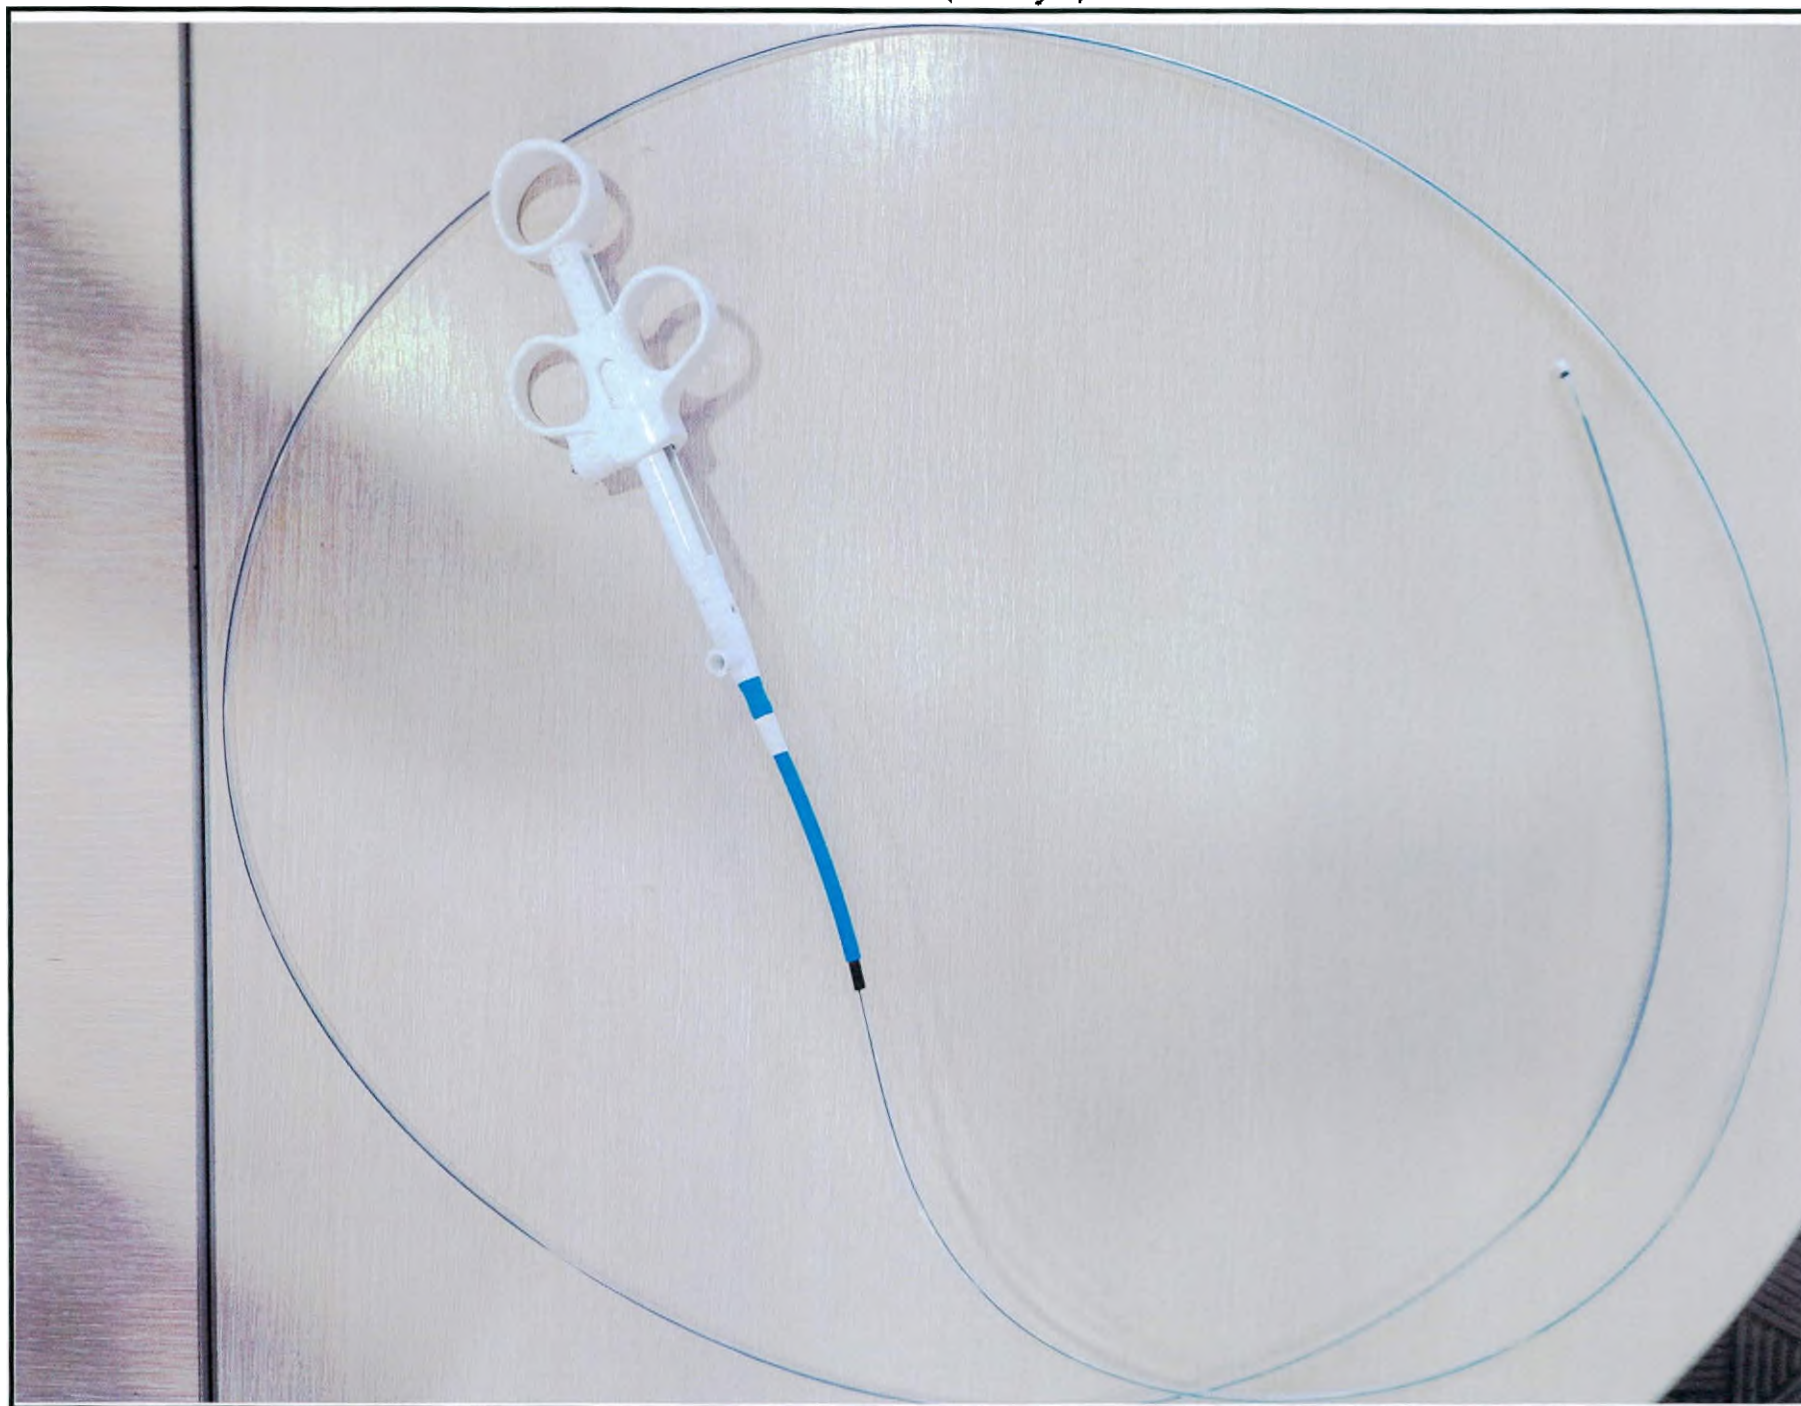

5. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2618J-B20- (1 шт./уп.)

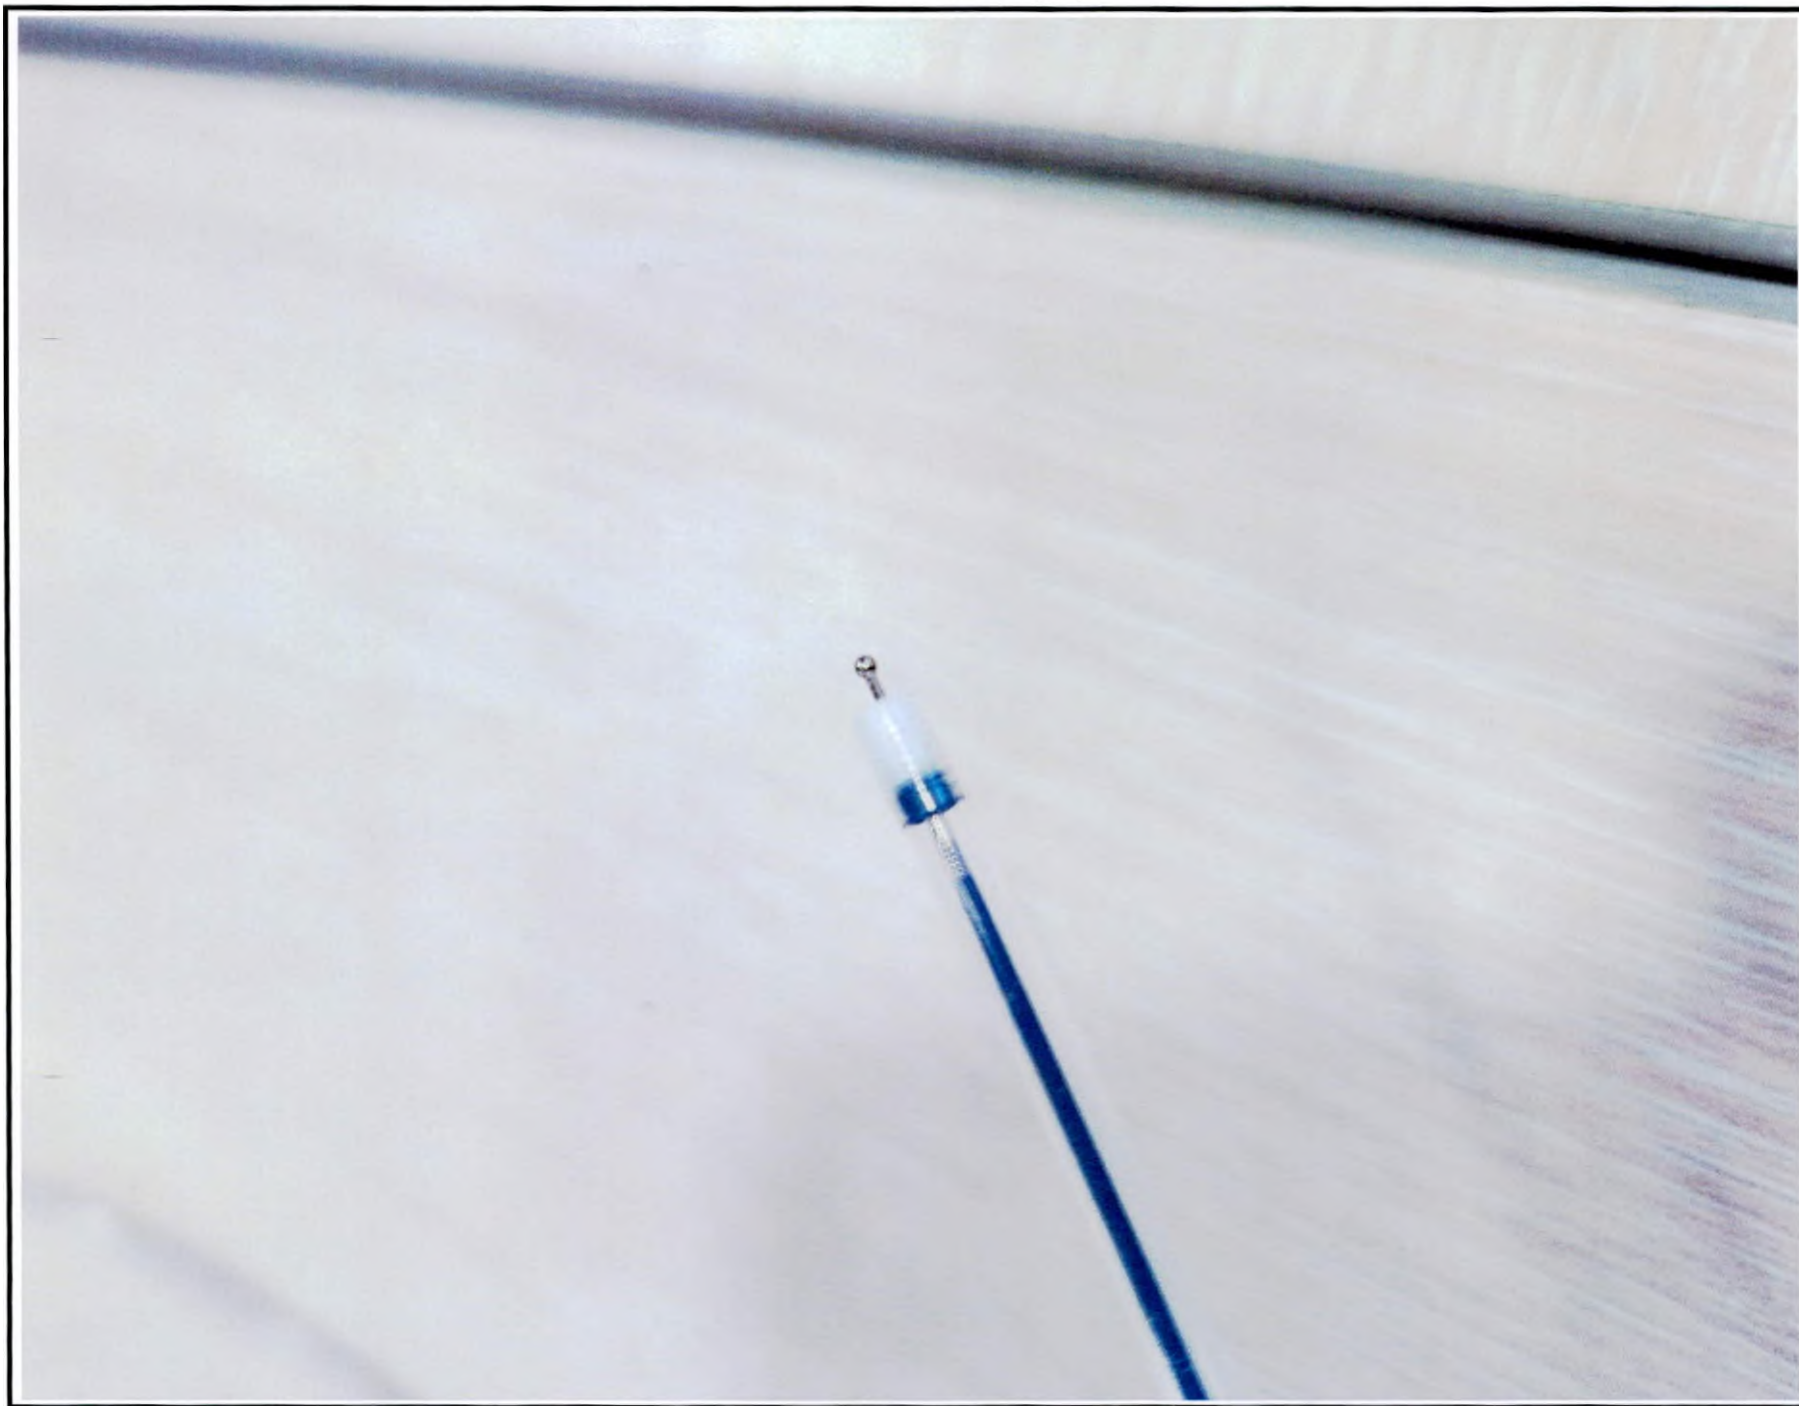

6. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения DK2618J-B30- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)

FUJIFILM **FT**

FlushKnife BT DK2618J -B30-

Diathermic Slitter

2.7mm
3.0mm

1800mm

en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 1800mm
de : Arbeitslänge : 1800mm
fr : Longueur utile : 1800mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 1800mm
es : Longitud de trabajo : 1800mm
pt : Comprimento de trabalho : 1800mm
nl : Werklengte : 1800mm
tr : Çalışma uzunluğu : 1800mm

en : Stored in a package box
de : In einer Produktverpackung aufbewahrt
fr : Rangé dans une boîte d'emballage

it : Conservato in una scatola della confezione
es : Almacenado en un embalaje
pt : Guardado numa embalagem
nl : Opgeslagen in een bewaardoos
tr : Ambalajda saklı

1 pc.

STERILE EO


CE 0123

2016-11

2013-12

LOT 1312A1

MADE IN JAPAN
1312A1



EU partner:
FUJIFILM Europe B.V.
Overstade 1, 5047 TK Tilburg
The Netherlands

Imported to Australia by:
FUJIFILM Australia Pty Ltd
14 Old Pittwater Road, Brookvale
NSW 2100, Australia

6. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2618J-B30- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)

FUJIFILM (FT)

FlushKnife BT **DK2618J -B30-**

Diathermic Slitter

2.7mm
3.0mm

1800mm

en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturf diatèrmico
pt : Cortador diatèrmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatèrmik Dilici

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 1800mm
de : Arbeitslänge : 1800mm
fr : Longueur utile : 1800mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 1800mm
es : Longitud de trabajo : 1800mm
pt : Comprimento de trabalho : 1800mm
nl : Werklengte : 1800mm
tr : Çalışma uzunluğu : 1800mm

GS1-128

(01) 04547410324129 (17) 161100 (10) 1312A1
DK2618J -B30- FF835A PI-0

STERILE EO

0123

2016-11

2013-12


LOT 1312A1

MADE IN JAPAN
1312A1

6. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
 DK2618J-B30- (1 шт./уп.) - стерильная упаковка



6. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани. остановки кровотечения
DK2618J-B30- (1 шт./уп.)

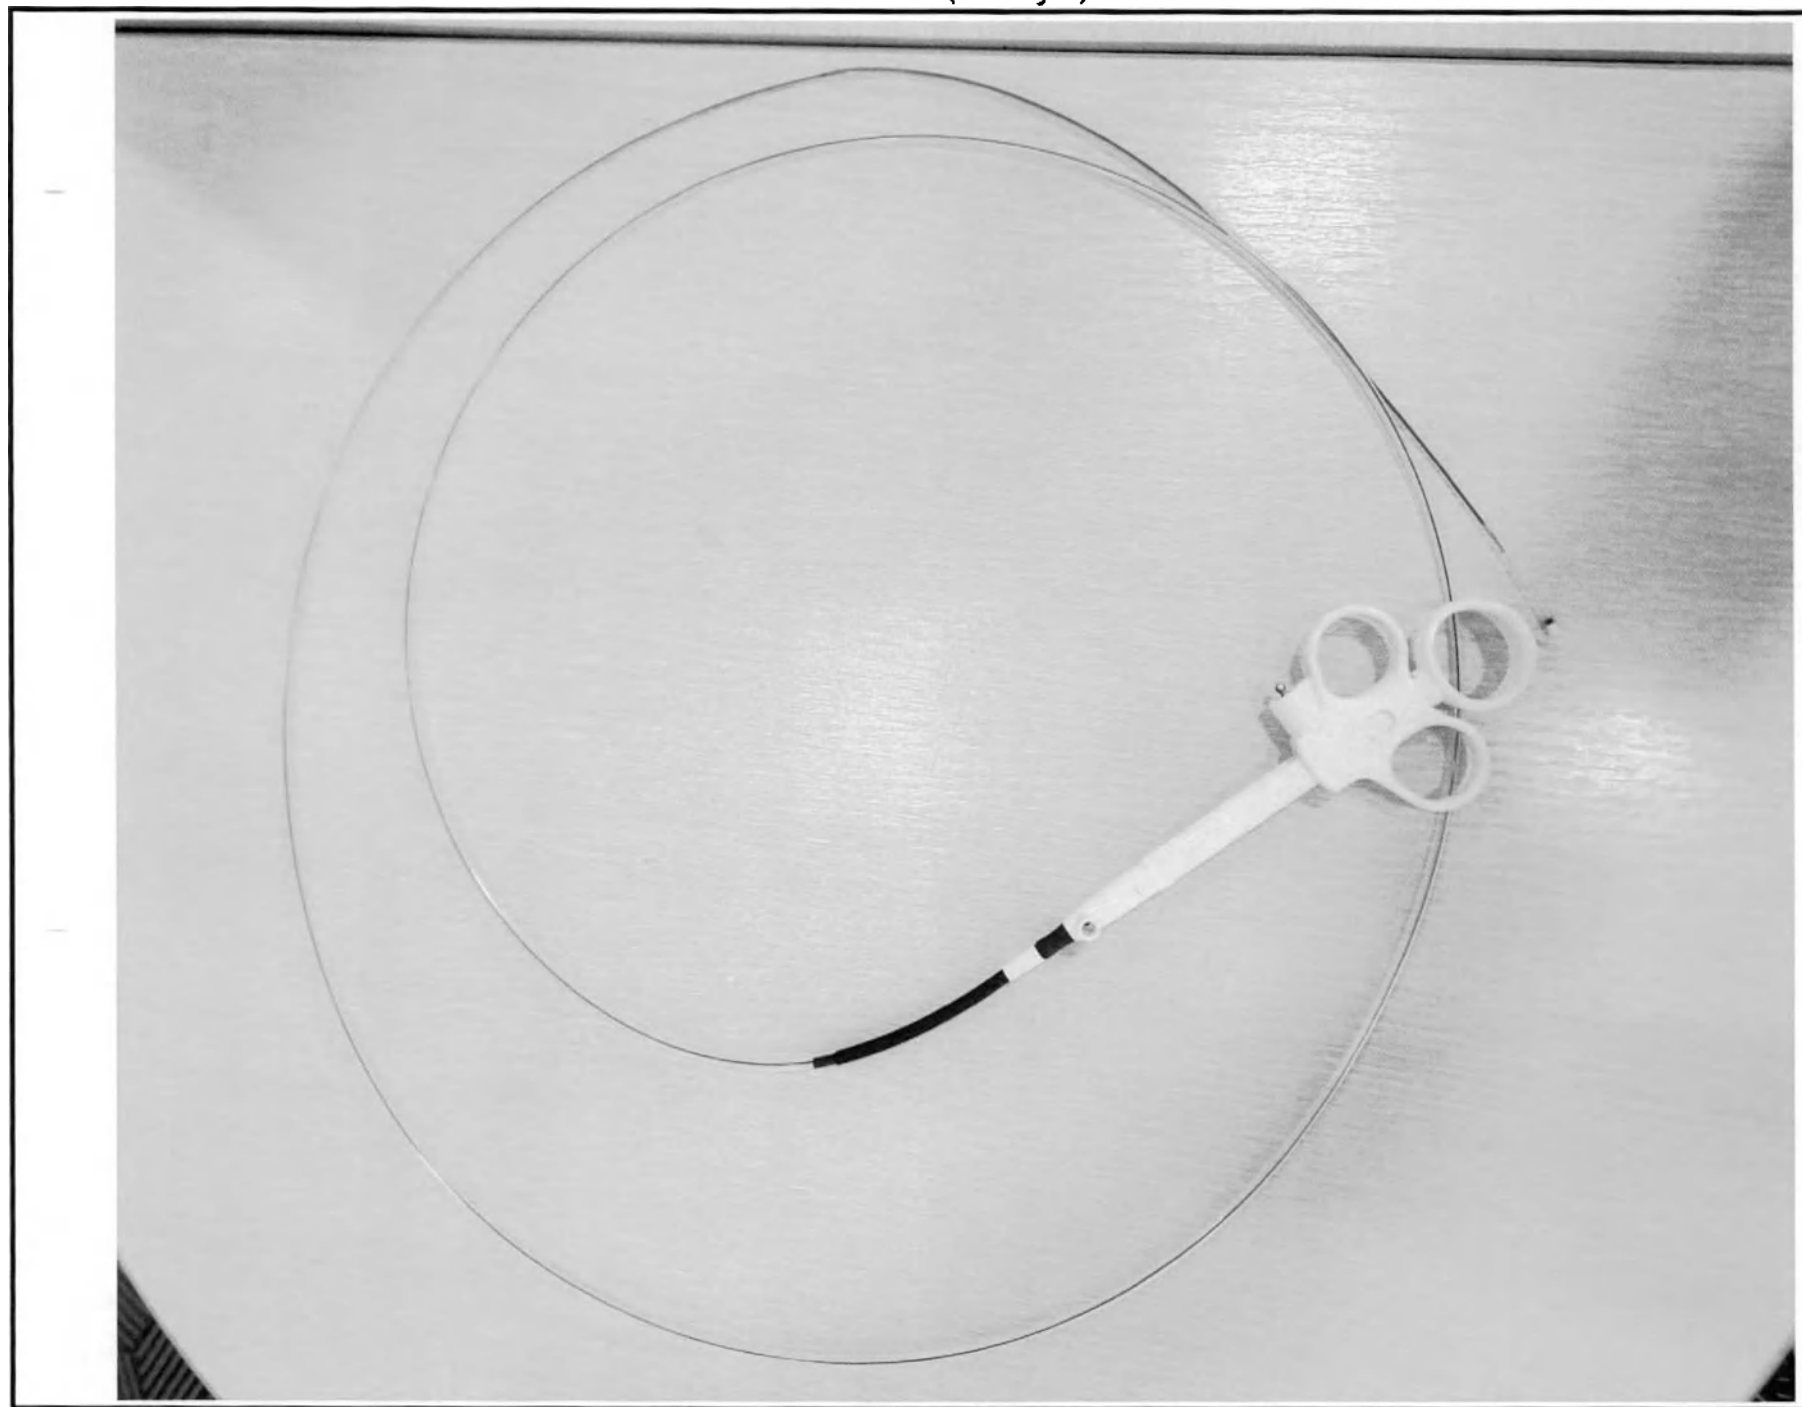

6. Пож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2618J-B30- (1 шт./уп.) (Круглый тип)



7. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2623J-N20- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)

FUJIFILM

(FT)

FlushKnife

DK2623J -N20-

Diathermic Slitter

2.7mm
2.0mm

en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilci

≥ 2.8mm

2300mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van Inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2300mm
de : Arbeitslänge : 2300mm
fr : Longueur utile : 2300mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2300mm
es : Longitud de trabajo : 2300mm
pt : Comprimento de trabalho : 2300mm
nl : Werklength : 2300mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2300mm

1 pc.

en : Stored in a package box
de : In einer Produktverpackung aufbewahrt
fr : Rangé dans une boîte d'emballage

it : Conservato in una scatola della confezione
es : Almacenado en un embalaje
pt : Guardado numa embalagem
nl : Opgeslagen in een bewaardoos
tr : Ambalajda saklı

-10°C +45°C

30% 95%

70kPa 106kPa

STERILE EO

CE 0123


2016-11

2013-12


LOT 1312A1

MADE IN JAPAN
1312A1

7. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2623J-N20- (1 шт./уп.)
(общий вид упаковки/картонной коробки)

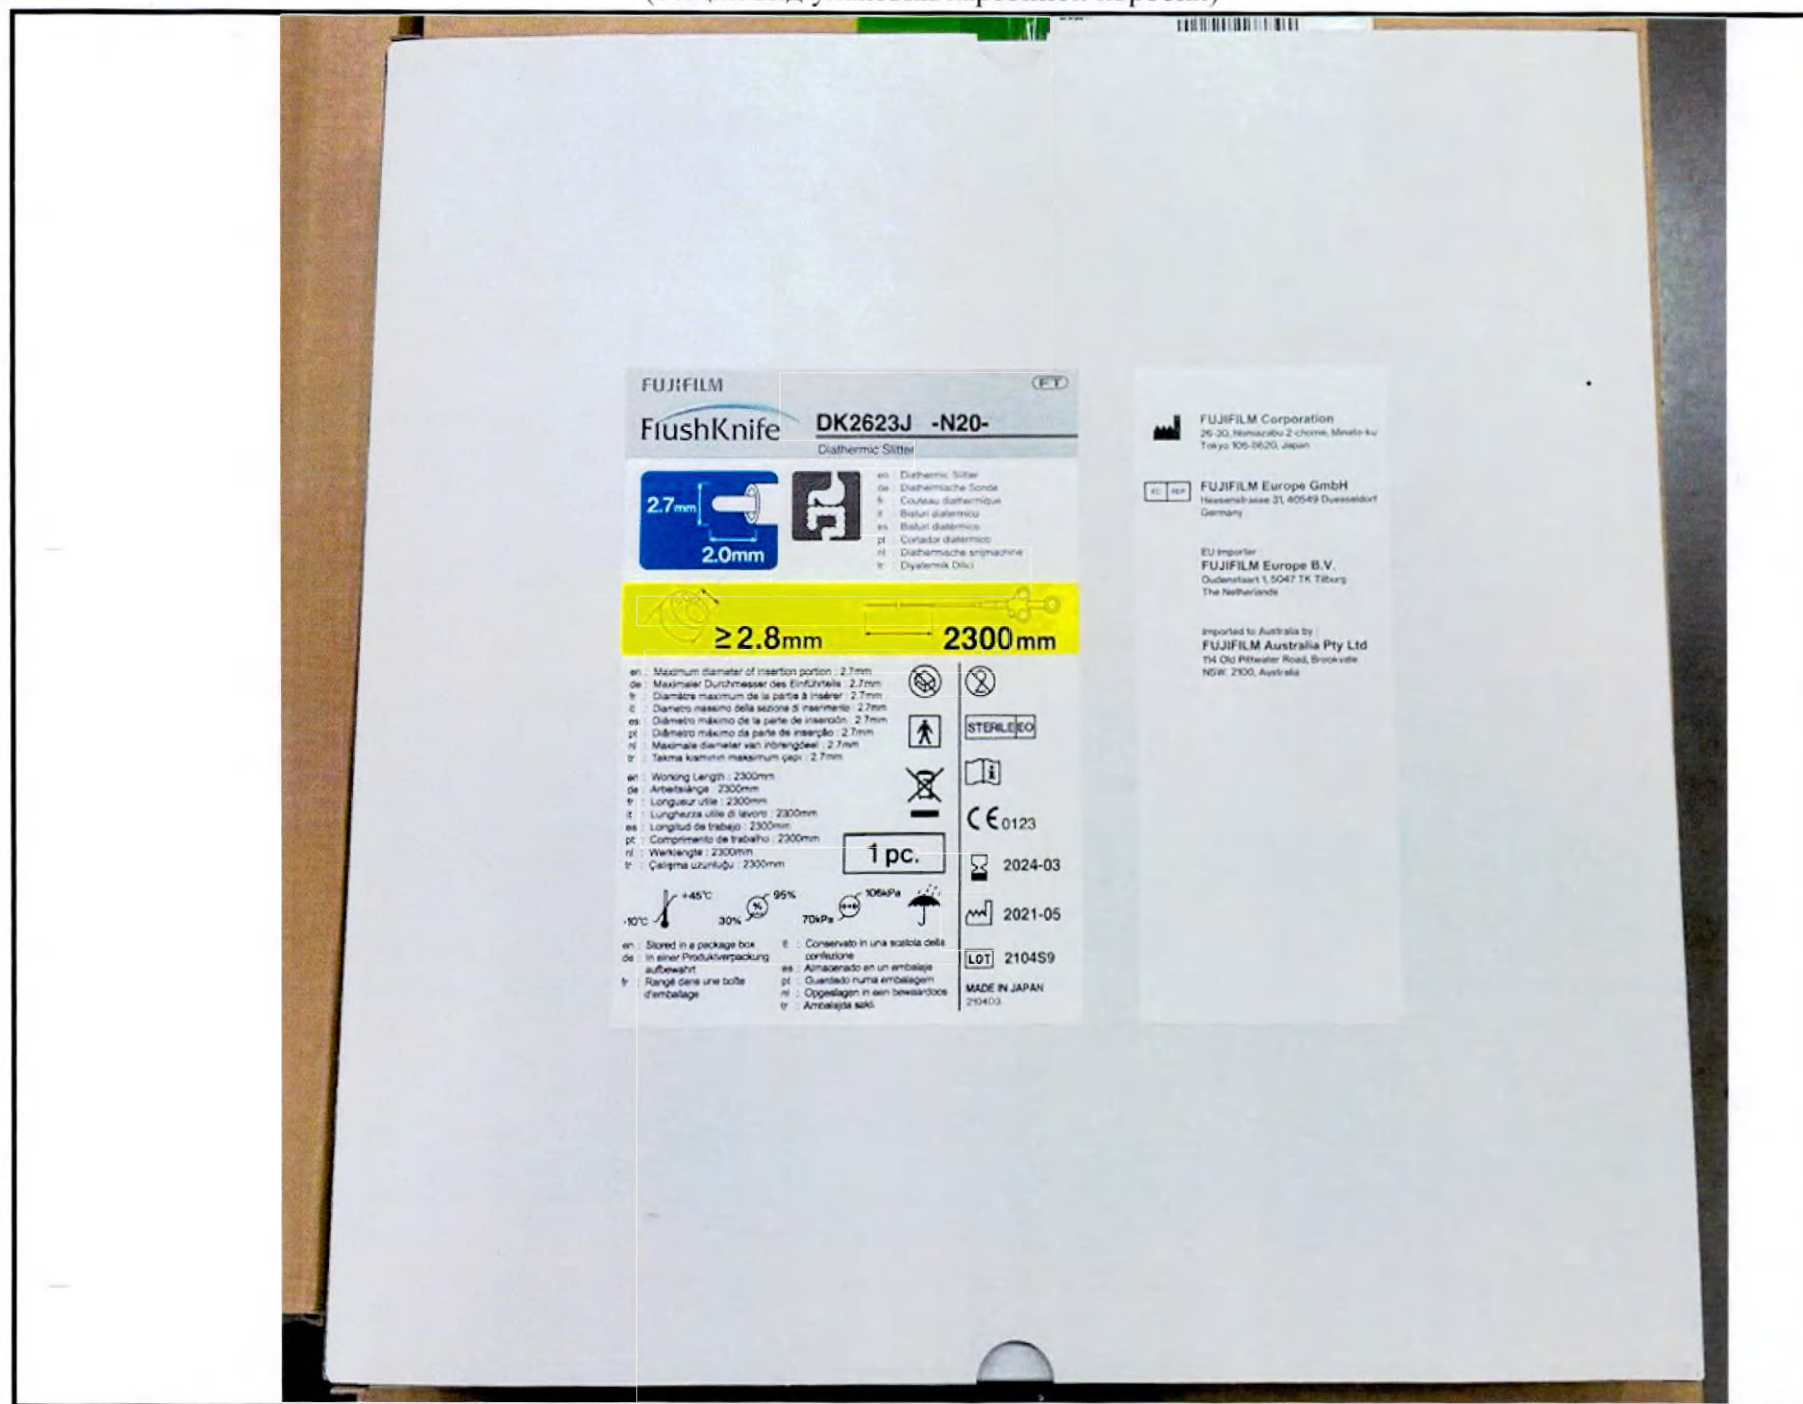

7. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2623J-N20- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)




FlushKnife

DK2623J -N20-

Diathermic Slitter





en : Diathermic Slitter
 de : Diathermische Sonde
 fr : Couteau diathermique
 it : Bisturi diatermico
 es : Bisturí diatérmico
 pt : Cortador diatérmico
 nl : Diathermische snijmachine
 tr : Diyatermik Dilici



≥2.8mm



2300mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
 de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
 fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
 it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
 es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
 pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
 nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
 tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2300mm
 de : Arbeitslänge : 2300mm
 fr : Longueur utile : 2300mm
 it : Lunghezza utile di lavoro : 2300mm
 es : Longitud de trabajo : 2300mm
 pt : Comprimento de trabalho : 2300mm
 nl : Werklengte : 2300mm
 tr : Çalışma uzunluğu : 2300mm















GS1-128




(01)04547410324211(17)161100(10)1312A1

DK2623J -N20- FF838A PI-0


7. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2623J-N20- (1 шт./уп.) - стерильная упаковка



7. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2623J-N20- (1 шт./уп.)

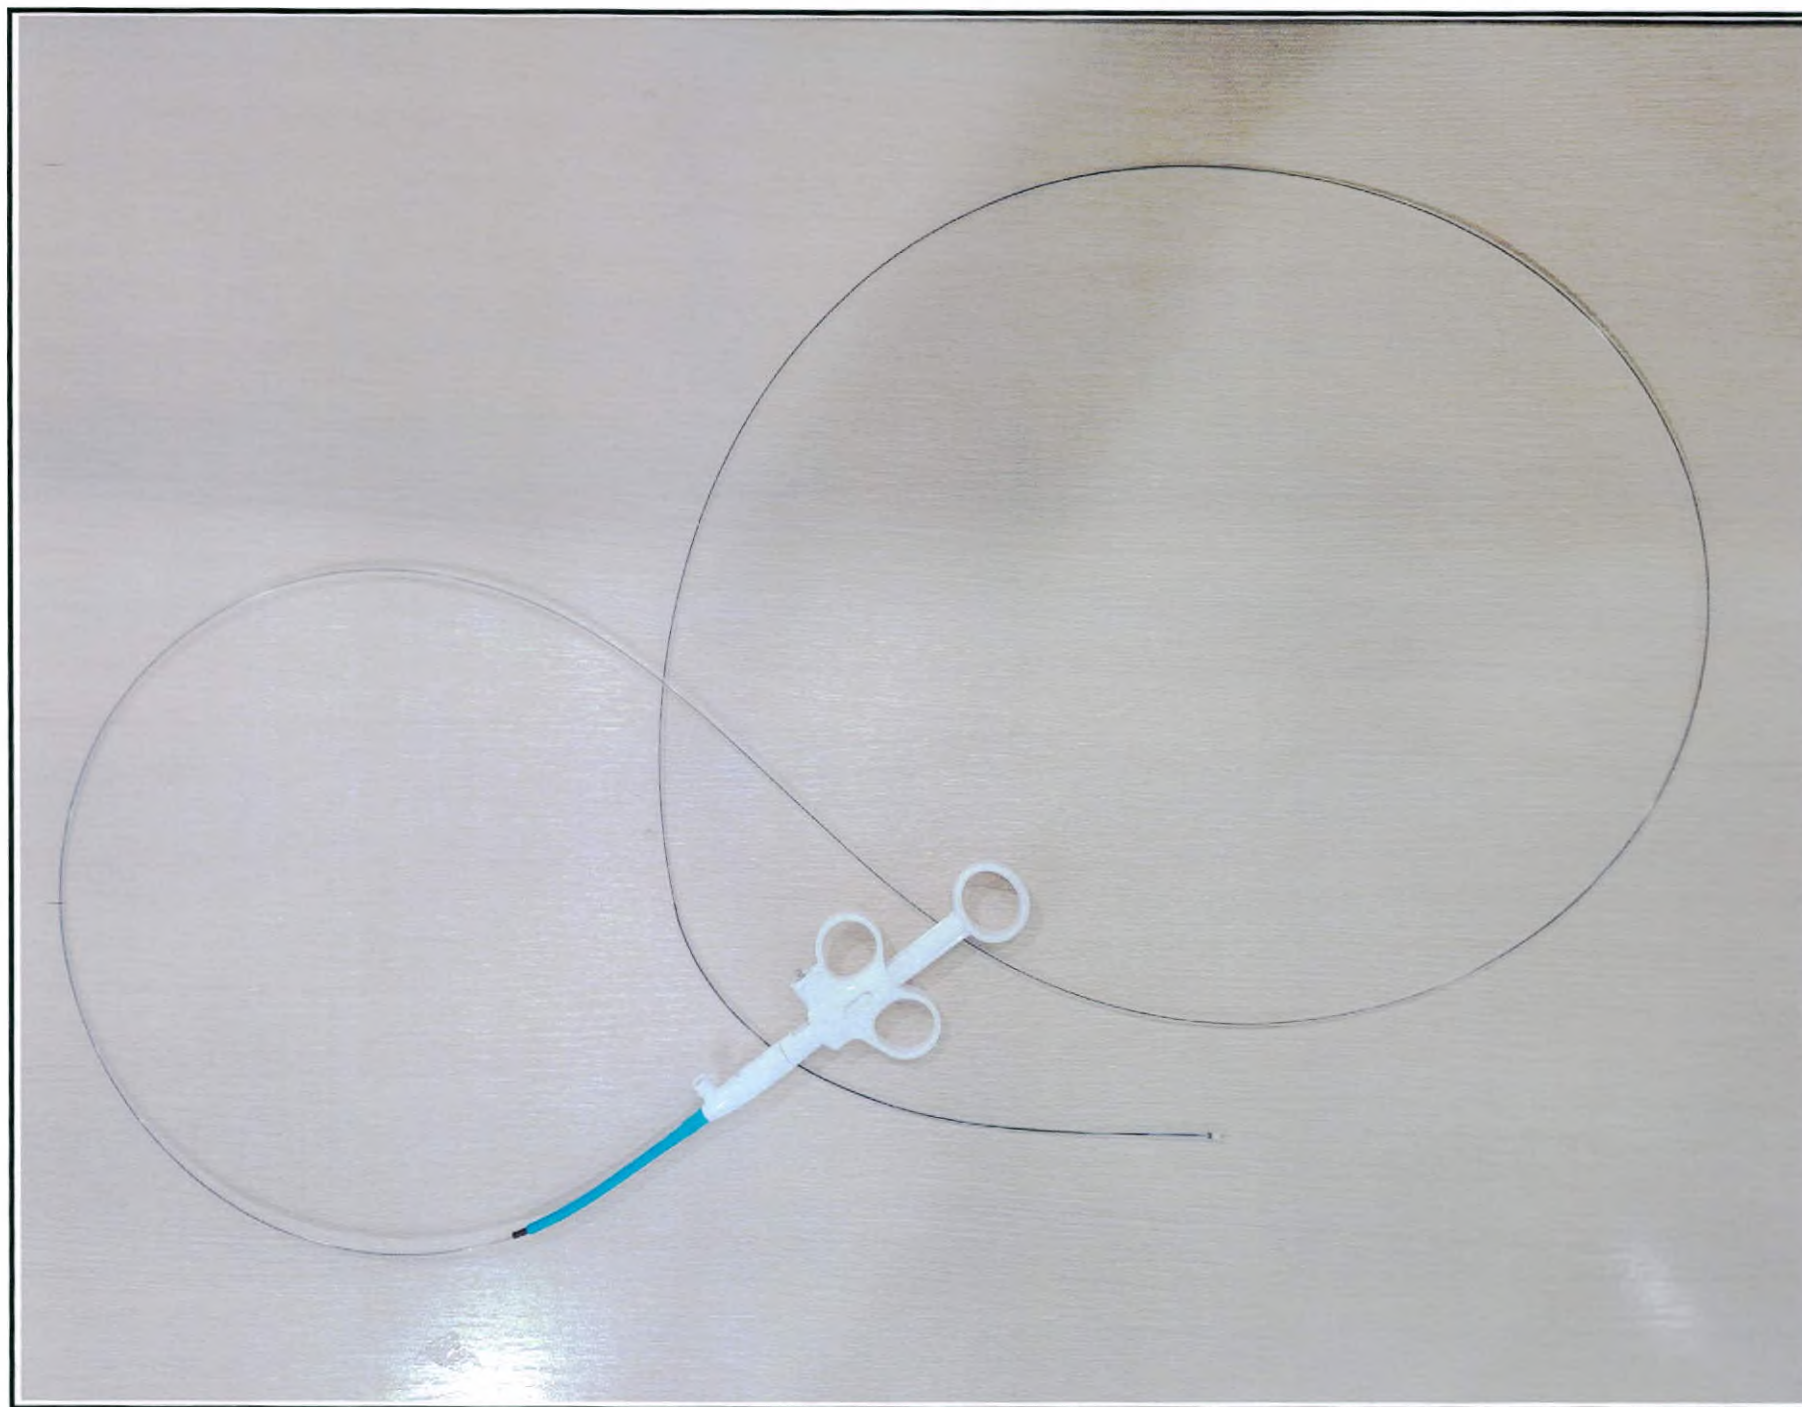

7. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2623J-N20- (1 шт./уп.) (Игольчатый тип)

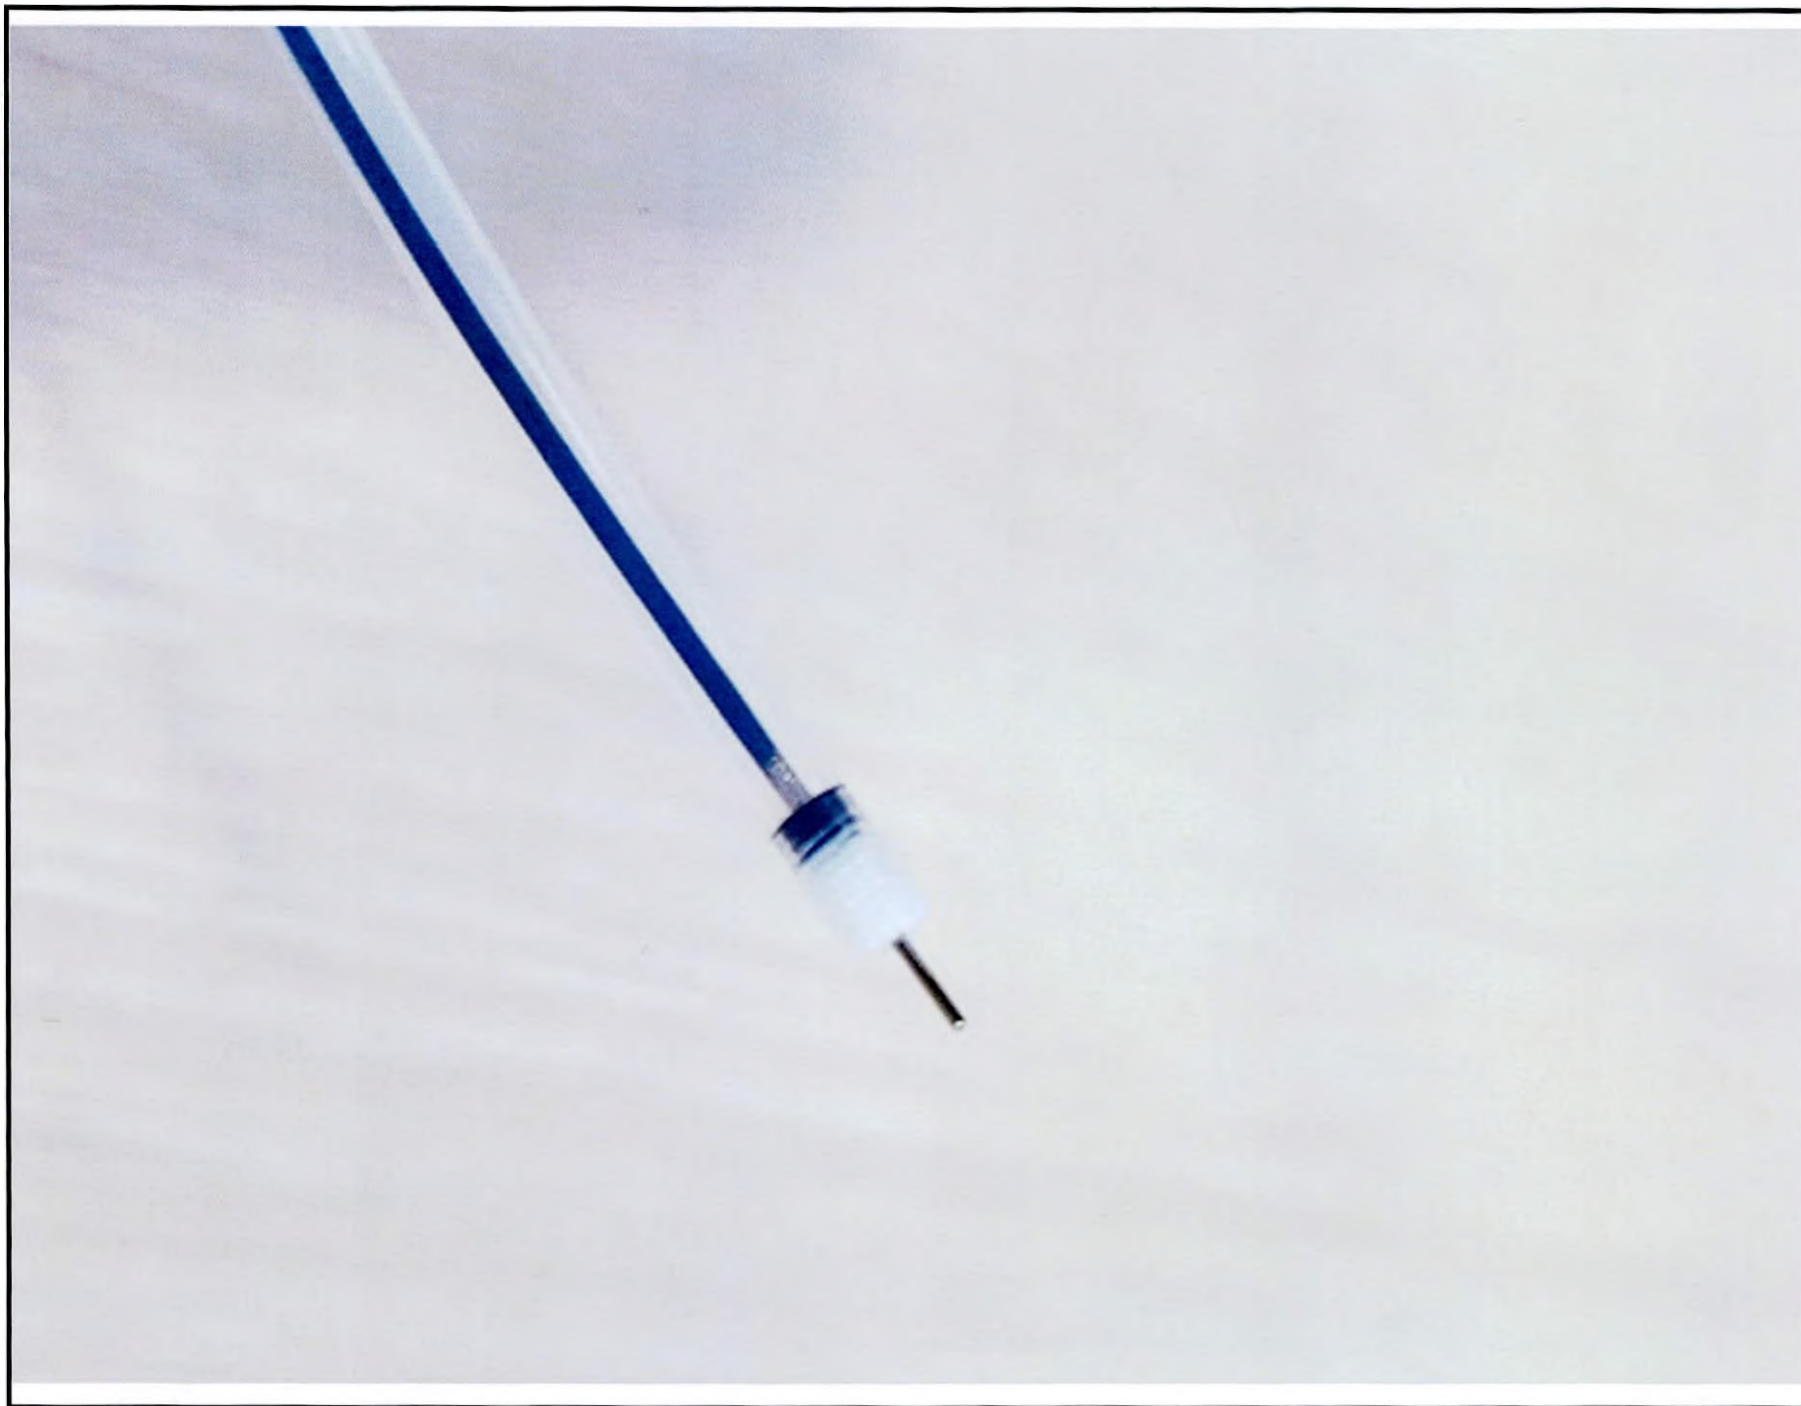

8. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623J-B15- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)


FUJIFILM

FT

FlushKnife BT

DK2623J -B15-

Diathermic Slitter



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturi diatérnico
pt : Cortador diatérnico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥2.8mm



2300mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2300mm
de : Arbeitslänge : 2300mm
fr : Longueur utile : 2300mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2300mm
es : Longitud de trabajo : 2300mm
pt : Comprimento de trabalho : 2300mm
nl : Werklengthe : 2300mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2300mm



1 pc.



+45°C

-10°C

30%

95%

70kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa

106kPa


en : Stored in a package box
de : In einer Produktverpackung
aufbewahrt
fr : Rangé dans une boîte
d'emballage

it : Conservato in una scatola della
confezione
es : Almacenado en un embalaje
pt : Guardado numa embalagem
nl : Opgeslagen in een bewaardoos
tr : Ambalajda saklı


LOT 1312A1

MADE IN JAPAN
1312A1

8. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623J-B15- (1 шт./уп.) - (общий вид упаковки/картонной коробки)

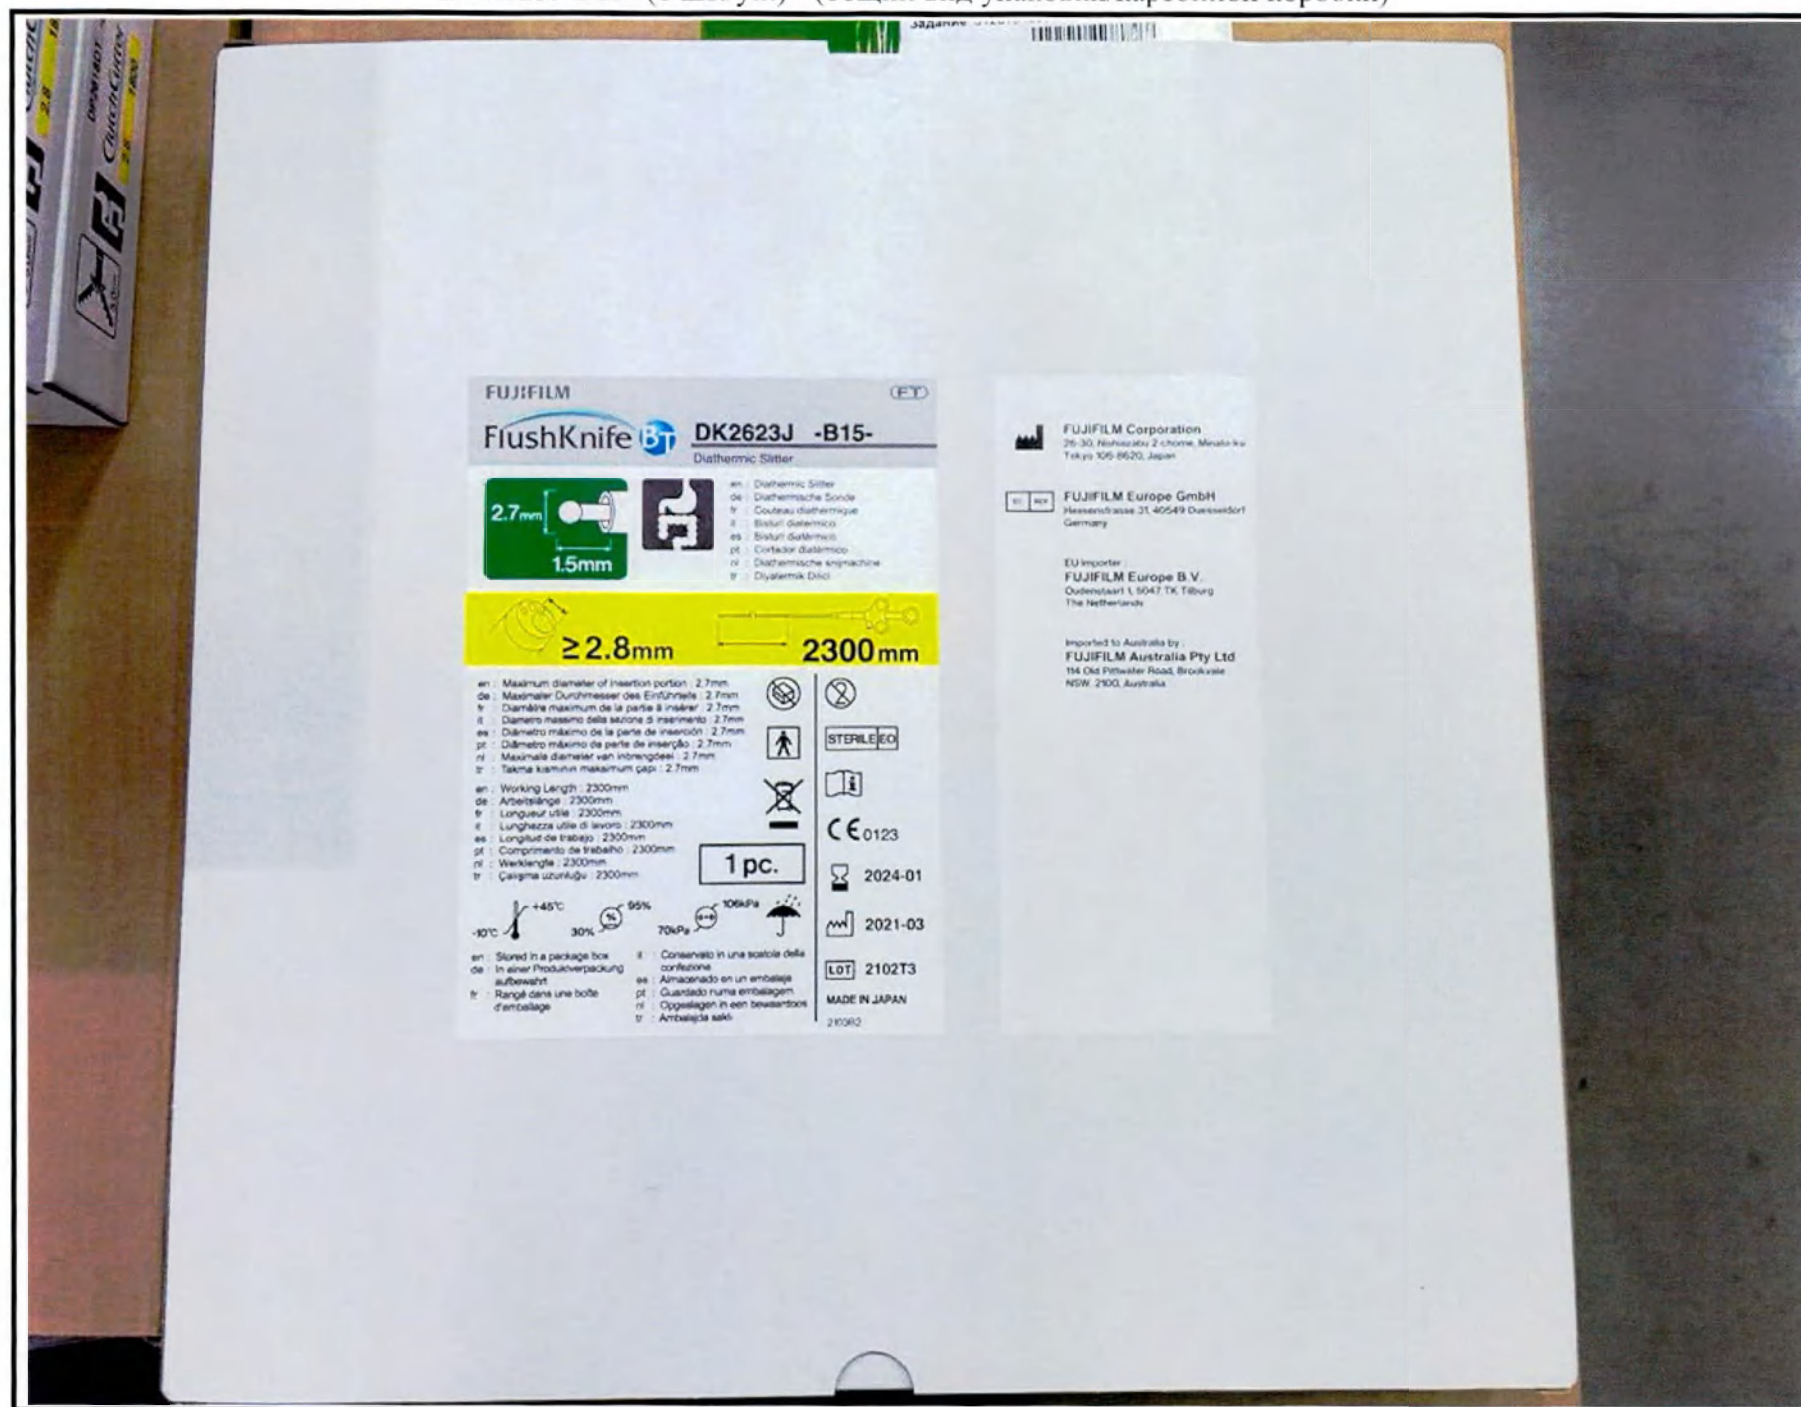


8. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623J-B15- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)




FlushKnife **BT** DK2623J -B15-

Diathermic Slitter




2.7mm
1.5mm



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥2.8mm



2300mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2300mm
de : Arbeitslänge : 2300mm
fr : Longueur utile : 2300mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2300mm
es : Longitud de trabajo : 2300mm
pt : Comprimento de trabalho : 2300mm
nl : Werklengte : 2300mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2300mm











GS1-128



(01) 04547410324181 (17) 161100 (10) 1312A1
DK2623J -B15- FF839A P1-0

STERILE EO

CE 0123

2016-11

2013-12


LOT 1312A1

MADE IN JAPAN
1312A1


8. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623J-B15- (1 шт./уп.) - стерильная упаковка



8. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623J-B15- (1 шт./уп.)

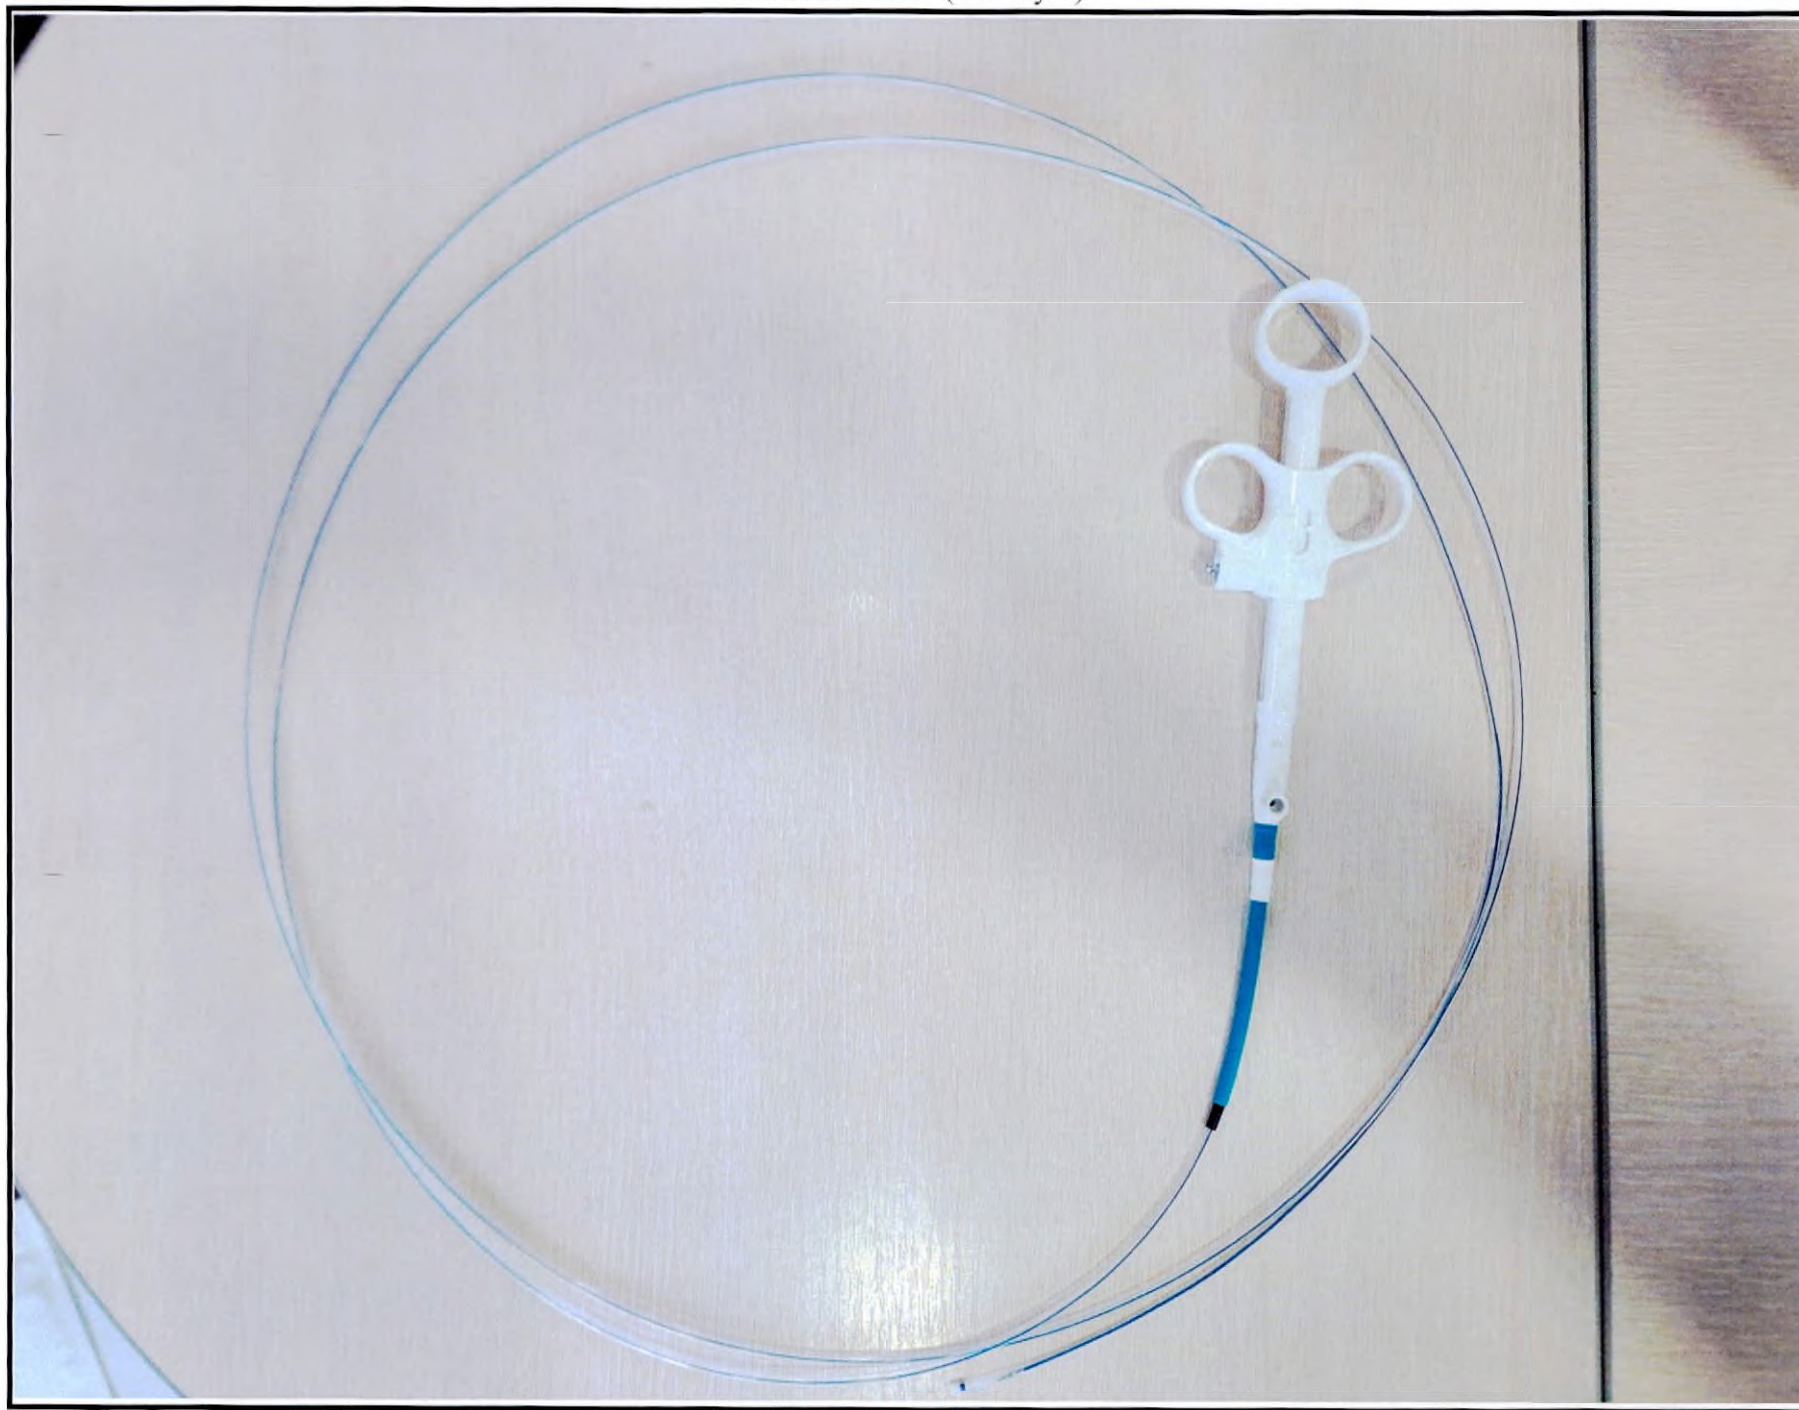

8. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623J-B15- (1 шт./уп.) (Круглый тип)

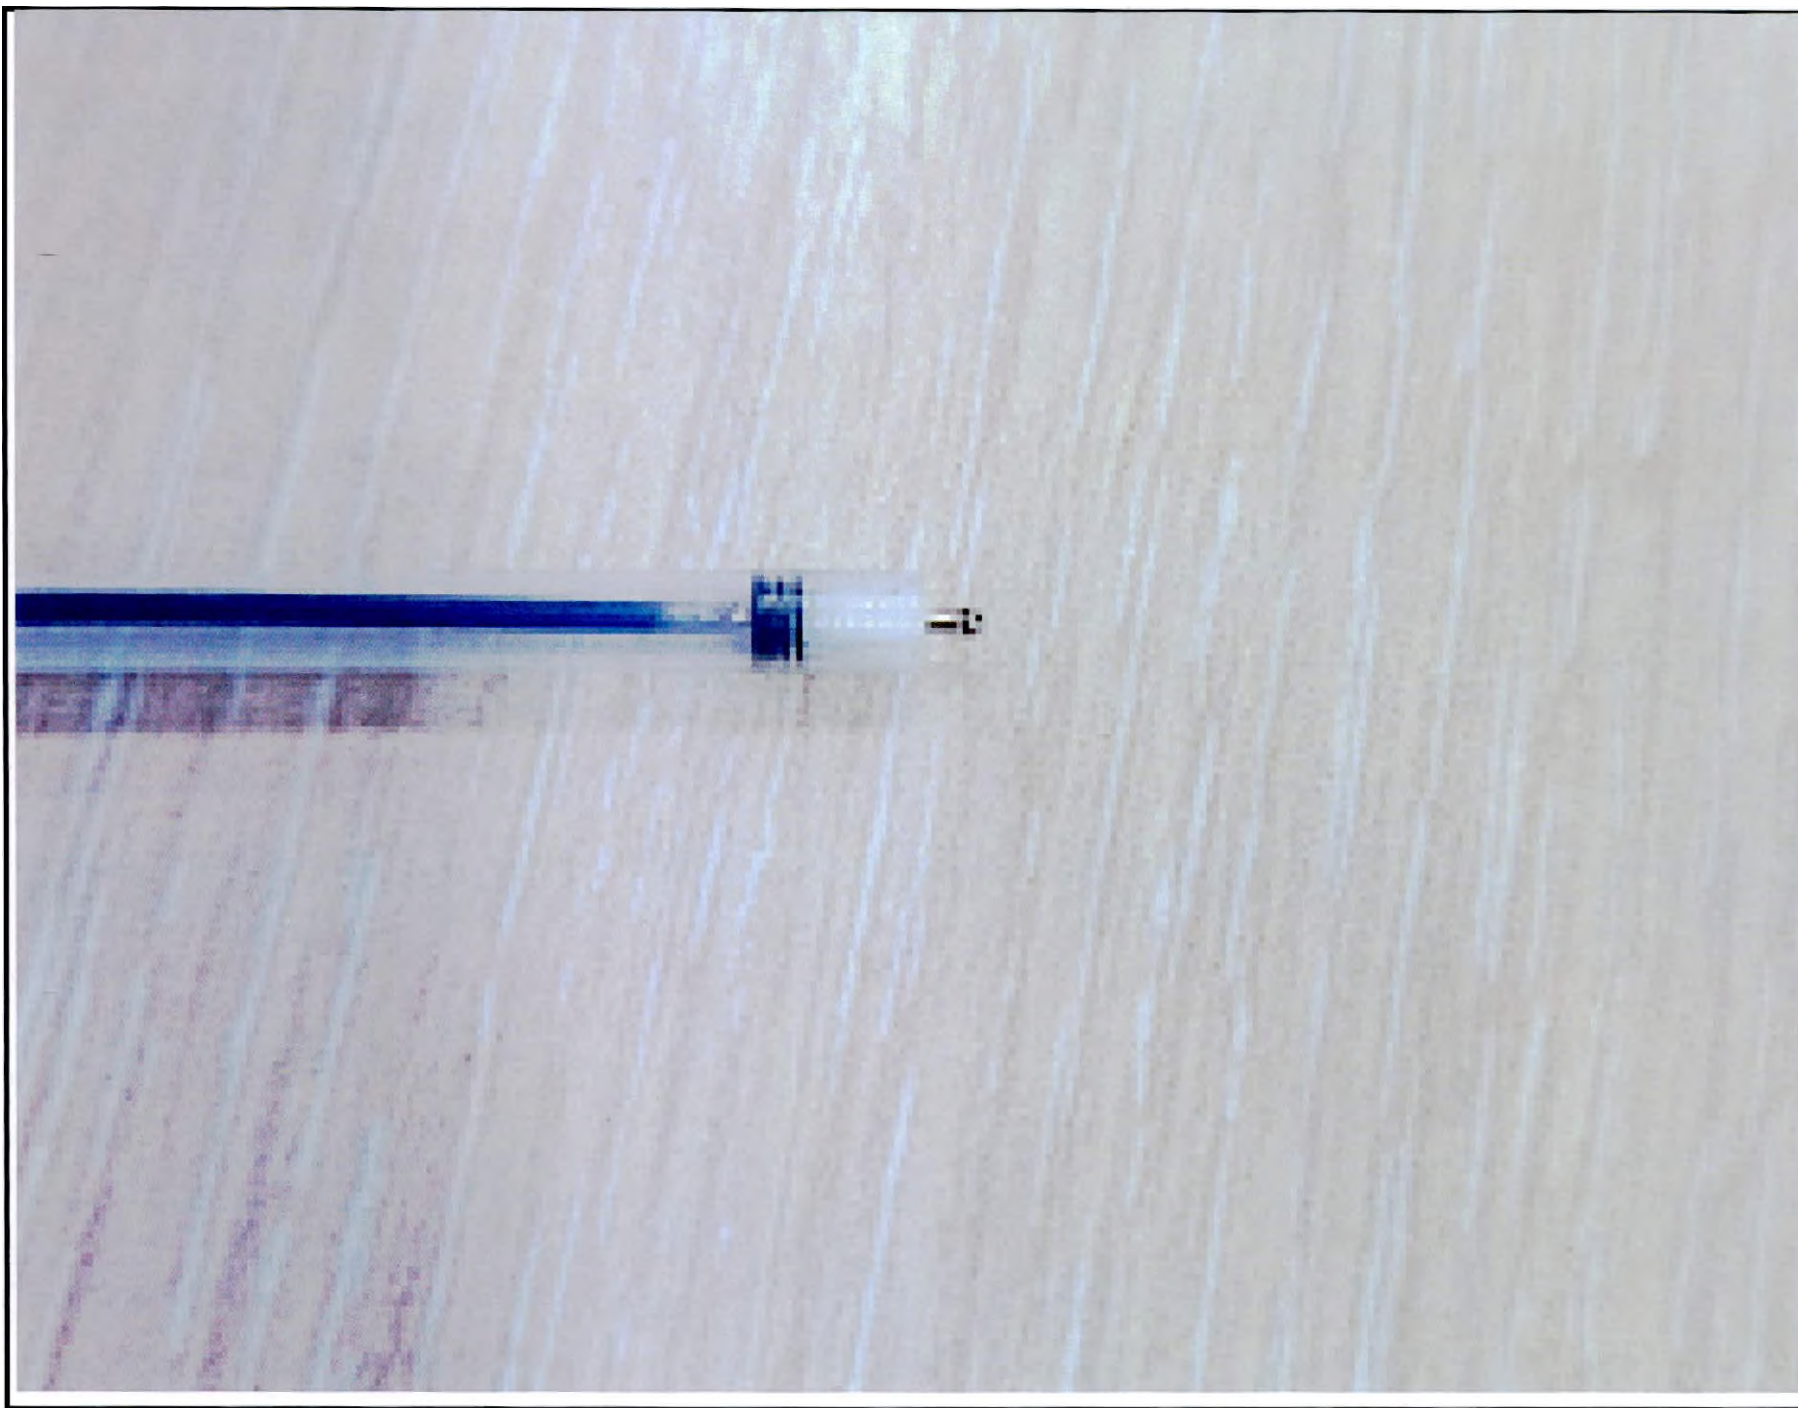


9. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623J-B20- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)




FlushKnife BT

DK2623J -B20-

Diathermic Slitter





en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturi diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥2.8mm




2300mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van Inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm


en : Working Length : 2300mm
de : Arbeitslänge : 2300mm
fr : Longueur utile : 2300mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2300mm
es : Longitud de trabajo : 2300mm
pt : Comprimento de trabalho : 2300mm
nl : Werklengte : 2300mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2300mm

















1 pc.



-10°C +45°C



30% 95%



70kPa 106kPa



en : Stored in a package box
de : In einer Produktverpackung aufbewahrt
fr : Rangé dans une boîte d'emballage

it : Conservato in una scatola della confezione
es : Almacenado en un embalaje
pt : Guardado numa embalagem
nl : Opgeslagen in een bewaardoos
tr : Ambalajda saklı

MADE IN JAPAN
1312A1

9. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623J-B20- (1 шт./уп.) - (общий вид упаковки/картонной коробки)



9. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623J-B20- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)


FUJIFILM

FT

FlushKnife BT

DK2623J -B20-

Diathermic Slitter



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥2.8mm



2300mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2300mm
de : Arbeitslänge : 2300mm
fr : Longueur utile : 2300mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2300mm
es : Longitud de trabajo : 2300mm
pt : Comprimento de trabalho : 2300mm
nl : Werklengte : 2300mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2300mm



STERILE EO



CE 0123

2016-11

2013-12

LOT 1312A1

MADE IN JAPAN
1312A1

GS1-128




(01) 045474 103241 98 (17) 161100 (10) 1312A1

DK2623J -B20- FF840A PI-0


9. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623J-B20- (1 шт./уп.) - стерильная упаковка



9. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623J-B20- (1 шт./уп.);

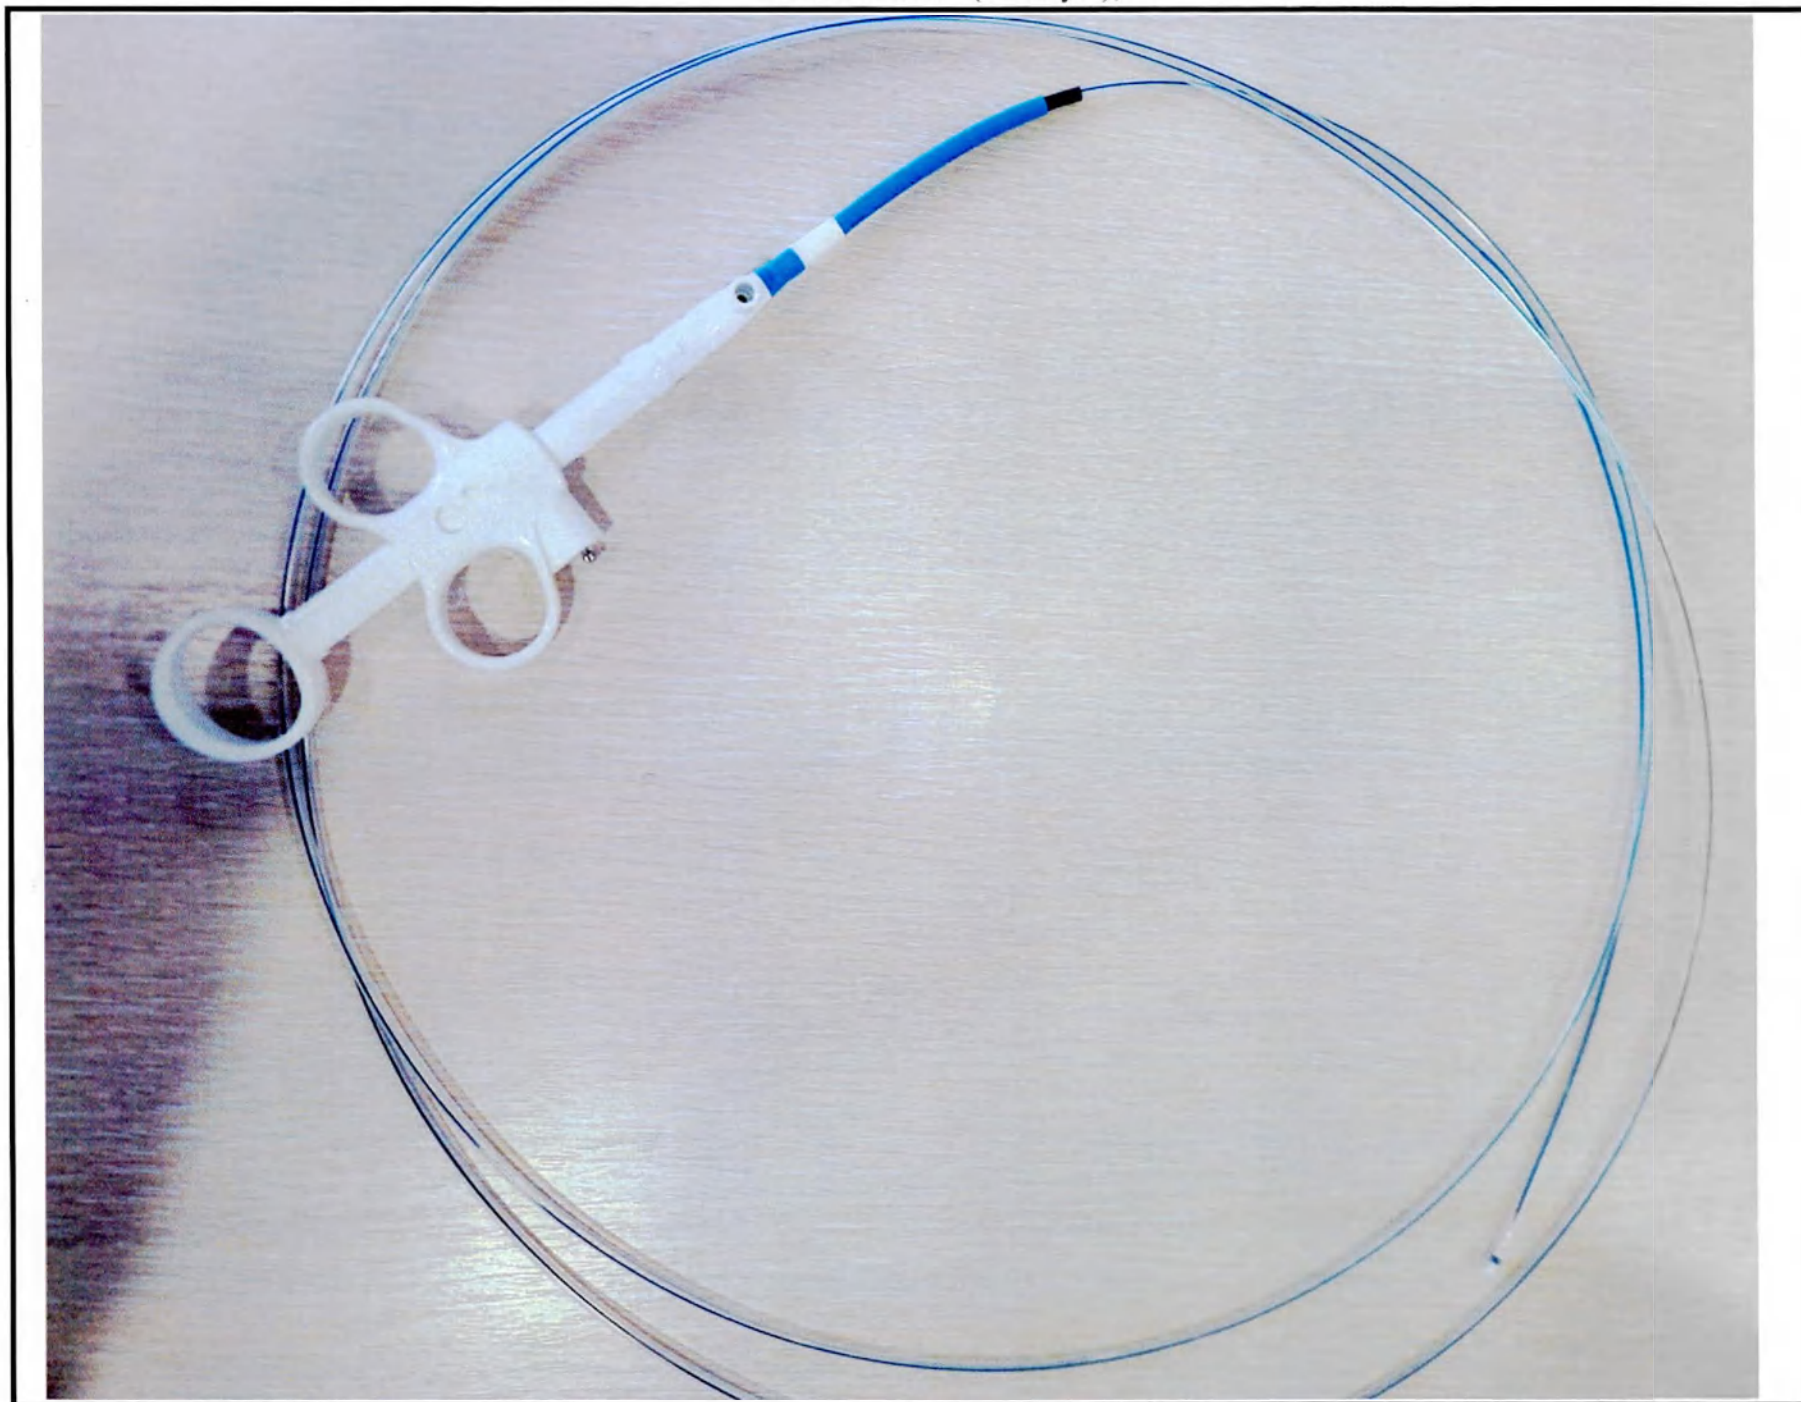

9. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623J-B20- (1 шт./уп.) (Круглый тип)

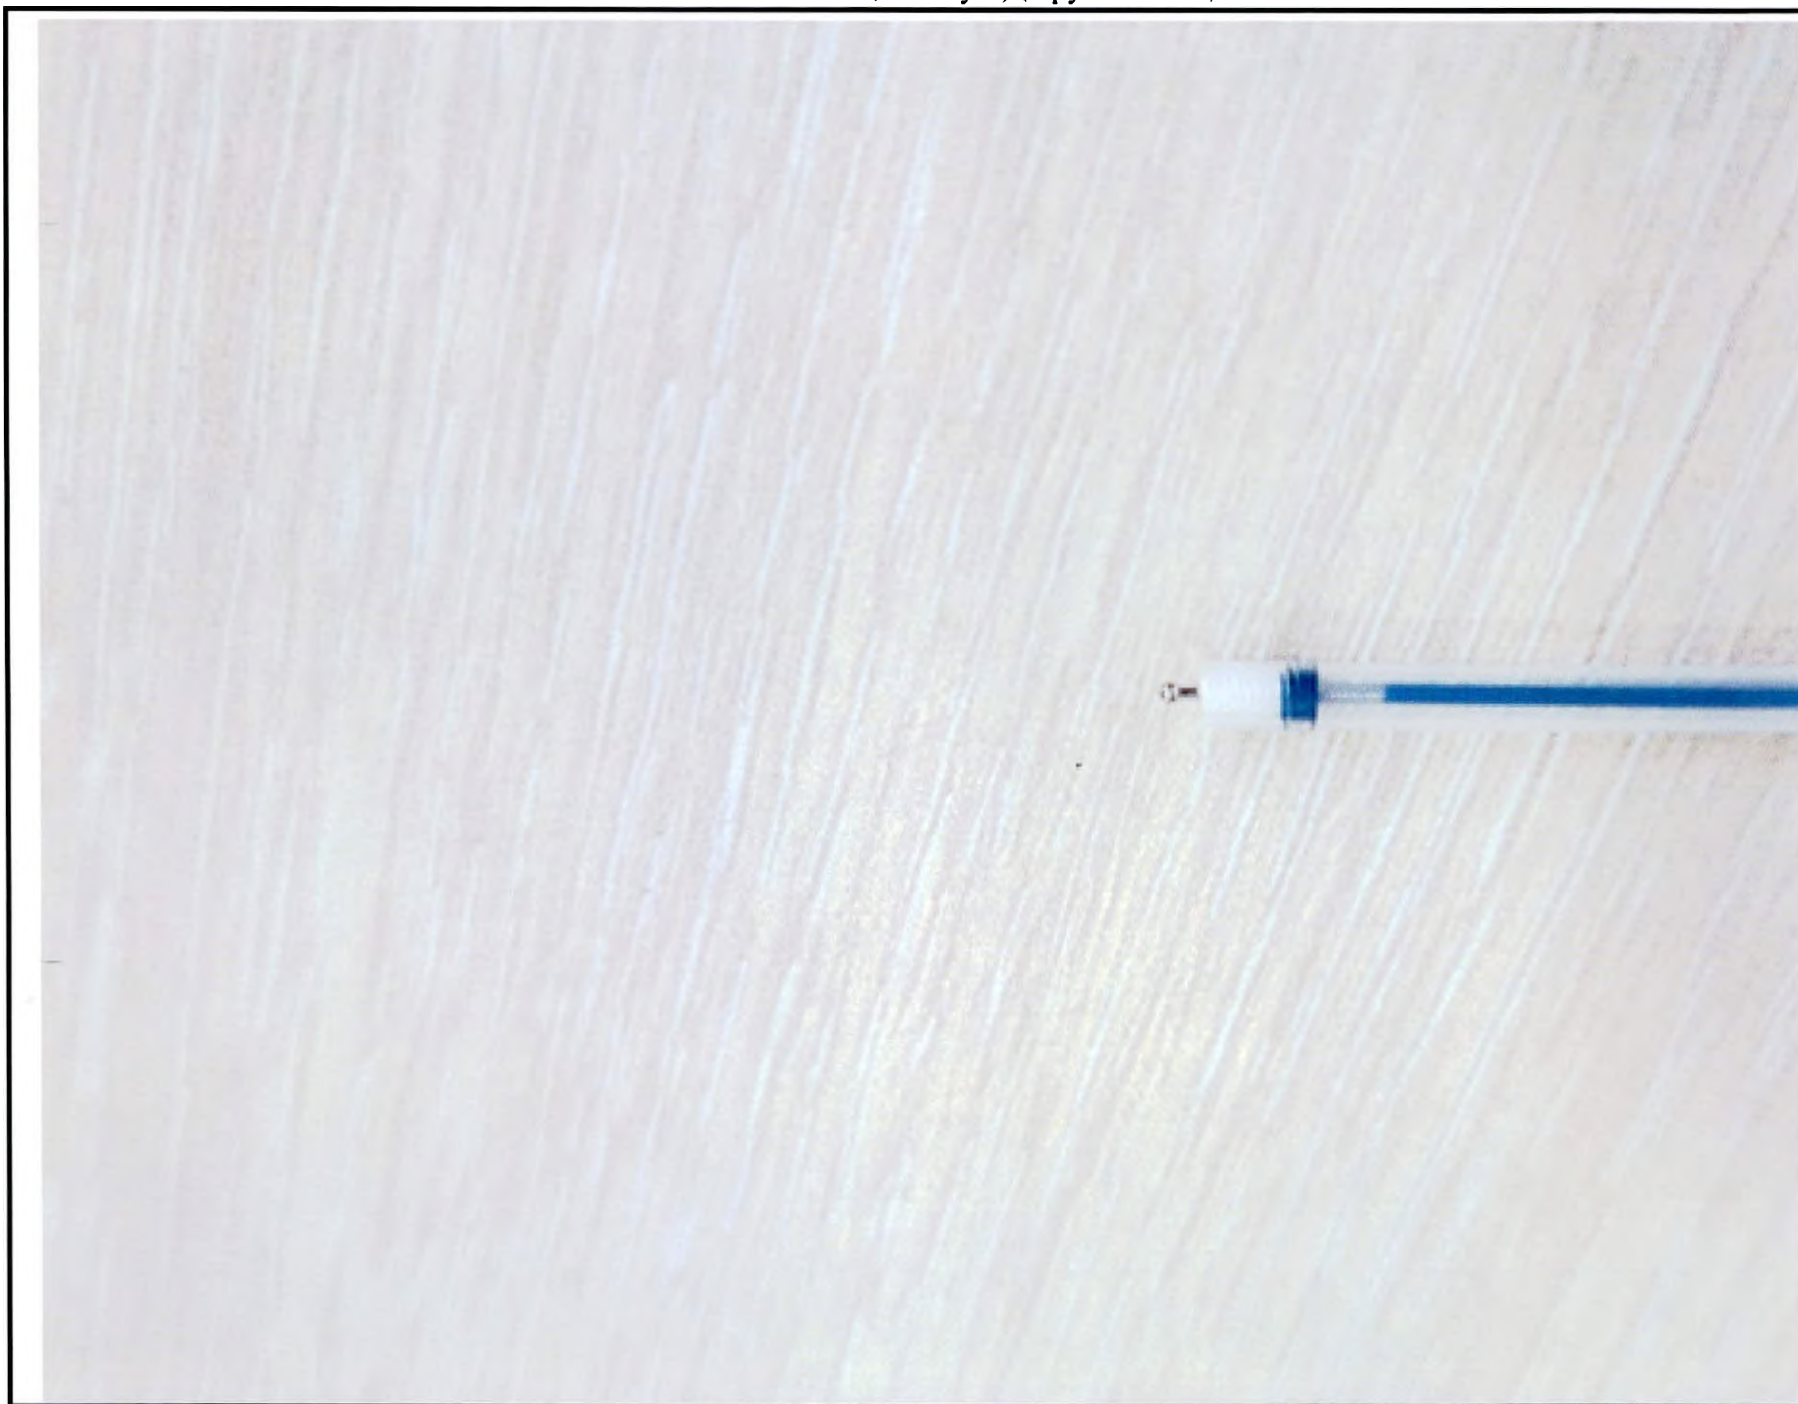

Дополнительная маркировка на картонной коробке для серии DK2620JI и DK2623JI:



-20°C
(-4°F)

+60°C
(+140°F)



10%

95%



70kPa
(10.2psia)

106kPa
(15.4psia)



Temperature / 温度 : -20 to +60°C (-4 to +140°F)

Humidity / 湿度 : 10 to 95% RH (No dew condensation / 結露状態を除く / 无结露)

Pressure / 気圧 / 气压 : 70 to 106kPa (10.2 to 15.4psia, 525 to 795mmHg)
(Within range of atmospheric pressure / 大気圧範囲 / 大气压范围以内)

en : Stored in a package box	pt : Guardado numa embalagem
de : In einer Produktverpackung aufbewahrt	nl : Opgeslagen in een bewaardoos
fr : Rangé dans une boîte d'emballage	tr : Ambalajda saklı
it : Conservato in una scatola della confezione	ja : 個装箱のまま保管
es : Almacenado en un embalaje	zh : 个别包装保管

10. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения DK2620JI-B15- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)


(FT)

FUJIFILM

FlushKnife **BTS** **DK2620JI -B15-**

Diathermic Slitter

2.7mm




1.5mm



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥ 2.8mm



2000mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
de : Arbeitslänge : 2000mm
fr : Longueur utile : 2000mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
es : Longitud de trabajo : 2000mm
pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
nl : Werklengte : 2000mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm





1 pc.



STERILE EO



CE 0123

2018-03

2015-04

LOT 1504A1

MADE IN JAPAN
1504A1

GS1-128



(01) XXXXXXXXXXXXXXX (17) XXXXXX (10) XXXXXX

DK2620JI -B15- FF931A PI-1

405Y200884B LN 20180331

10. Пож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, остановки кровотечения
DK2620JI-B15- (1 шт./уп.) - (общий вид упаковки/картонной коробки)

FUJIFILM

FlushKnife BTs DK2620JI -B15-

Diathermic Sitter

2.7mm
1.5mm

≥ 2.8mm
2000mm

en: Maximum diameter of insertion portion: 2.7mm
de: Maximaler Durchmesser des Einführteils: 2.7mm
fr: Diamètre maximum de la partie à insérer: 2.7mm
es: Diámetro máximo de la sección de inserción: 2.7mm
pt: Diâmetro máximo da parte de inserção: 2.7mm
nl: Maximale diameter van inbrengdeel: 2.7mm
tr: Takma kısmının maksimum çapı: 2.7mm

en: Working Length: 2000mm
de: Arbeitslänge: 2000mm
fr: Longueur utile: 2000mm
es: Longhezza utile di lavoro: 2000mm
pt: Comprimento de trabalho: 2000mm
nl: Werkleegte: 2000mm
tr: Çalışma uzunluğu: 2000mm

1 pc.

GS1-128
(01)14547410375821(17)240700(10)2108T3
DK2620JI-B15-FF931A PI-1

STERILE/EO

CE 0123

2024-07

2021-09

LOT 2108T3

MADE IN JAPAN
2109A9

FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku
Tokyo 106-8620, Japan

FUJIFILM Europe GmbH
Heesenstrasse 31, 40549 Duesseldorf, Germany

EU Importer:
FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, The Netherlands

Imported to Australia by:
FUJIFILM Australia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road, Brookvale, NSW, 2100
Australia

FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG
Sumphstrasse 13, 6312 Steinhausen, Switzerland

405N204380A


10. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2620JI-B15- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)

FUJIFILM


(FT)

FlushKnife **BTs****DK2620JI -B15-**

Diathermic Slitter



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici

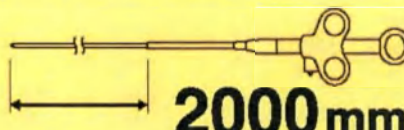**≥2.8mm****2000mm**

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
de : Arbeitslänge : 2000mm
fr : Longueur utile : 2000mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
es : Longitud de trabajo : 2000mm
pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
nl : Werklength : 2000mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm

**STERILE EO****CE 0123****2018-03****2015-04****LOT 1504A1****MADE IN JAPAN
1504A1**

GS1-128




(01)XXXXXXXXXXXXXXX(17)XXXXXX(10)XXXXXX

DK2620JI -B15- FF931A PI-0



10. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2620JI-B15- (1 шт./уп.)

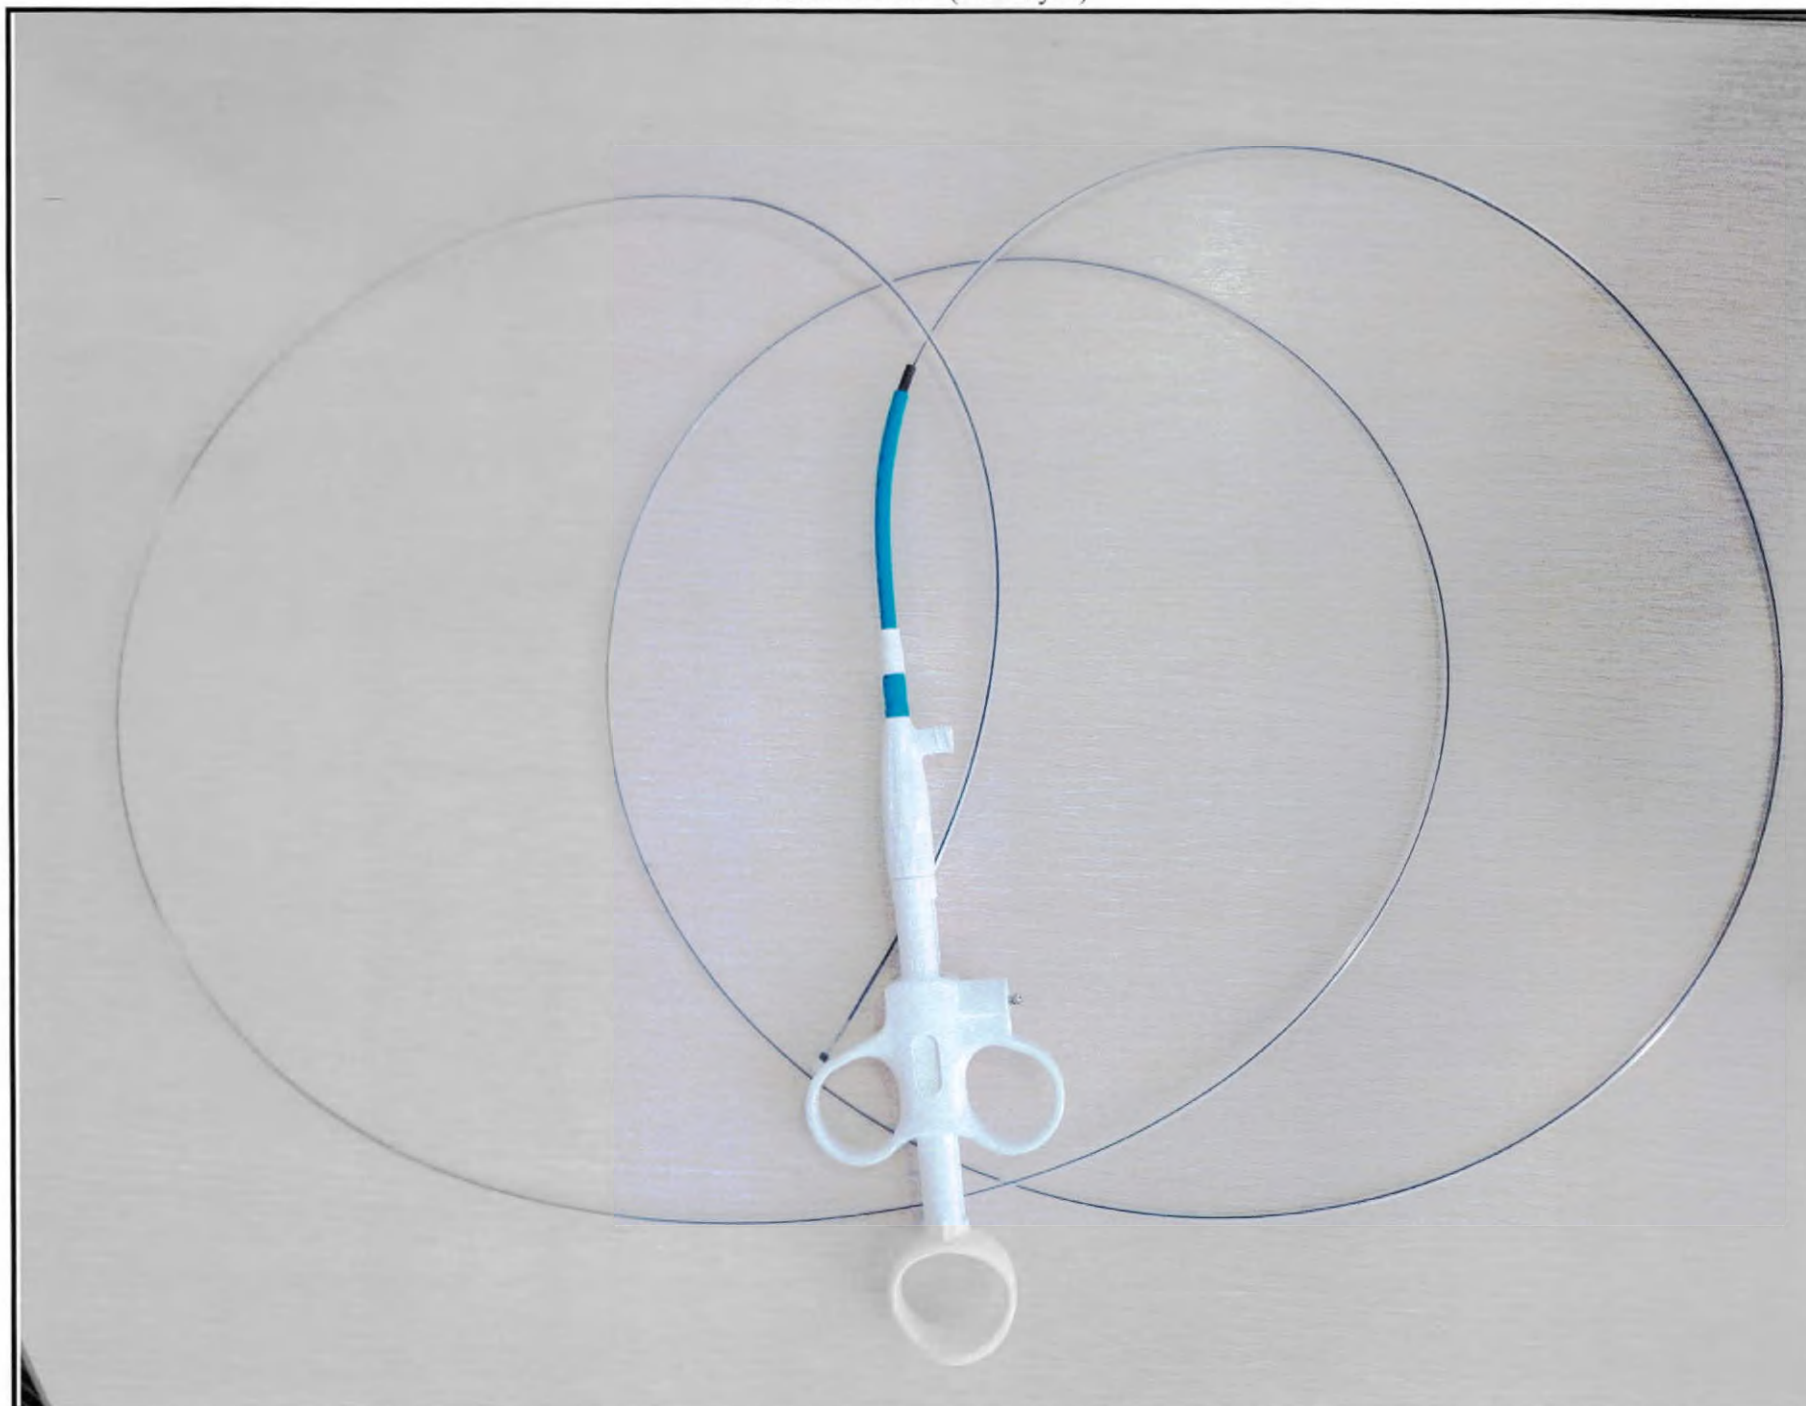

10. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2620JI-B15- (1 шт./уп.) (Круглый тип)




11. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2620JI-B20- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)

FUJIFILM


(FT)

FlushKnife **BTs****DK2620JI -B20-**

Diathermic Slitter



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici

**≥ 2.8mm****2000mm**

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
de : Arbeitslänge : 2000mm
fr : Longueur utile : 2000mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
es : Longitud de trabajo : 2000mm
pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
nl : Werklengte : 2000mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm



STERILE EO



CE 0123

2018-03

2015-04

LOT 1504A1

MADE IN JAPAN

1504A1

GS1-128



(01) XXXXXXXXXXXXXXX (17) XXXXXX (10) XXXXXX

DK2620JI -B20- FF932A PI-1

405Y200885B

LN 20180331

11. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения DK2620JI-B20- (1 шт./уп.) (общий вид упаковки/картонной коробки)

FUJIFILM **FlushKnife BTs** **DK2620JI -B20-**
Diathermic Slitter

2.7mm
2.0mm

≥ 2.8mm **2000mm**

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum papi : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
de : Arbeitslänge : 2000mm
fr : Longueur utile : 2000mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
es : Longitud de trabajo : 2000mm
pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
nl : Werk lengte : 2000mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm

1 pc.

STERILE EO

CE 0123

2024-06

2021-08

LOT 2107T3

MADE IN JAPAN

2106A3

GS1-128
[01]14547410375838[17]240600[10]2107T3
DK2620JI-B20-FF932A-PI-1

FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku
Tokyo 106-8620, Japan

FUJIFILM Europe GmbH
Heesenstrasse 31, 40549 Düsseldorf, Germany

EU Importer :
FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, The Netherlands

Imported to Australia by :
FUJIFILM Australia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road, Brookvale, NSW, 2100
Australia

FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG
Sumpfstrasse 13, 6312 Steinhausen, Switzerland

405A204386A

11. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения DK2620JI-B20- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)


FUJIFILM

(FT)

FlushKnife BTs

DK2620JI -B20-


Diathermic Slitter



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥ 2.8mm

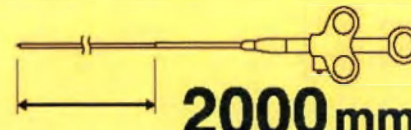

2000mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
de : Arbeitslänge : 2000mm
fr : Longueur utile : 2000mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
es : Longitud de trabajo : 2000mm
pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
nl : Werklengte : 2000mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm



STERILE EO



CE 0123



2018-03



2015-04



LOT 1504A1

MADE IN JAPAN

1504A1

GS1-128




(01) XXXXXXXXXXXXX (1) XXXXXX (10) XXXXXX

DK2620JI -B20- FF932A PI-0


11. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения DK2620JI-B20- (1 шт./уп.) - стерильная упаковка



11. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2620JI-B20- (1 шт./уп.)

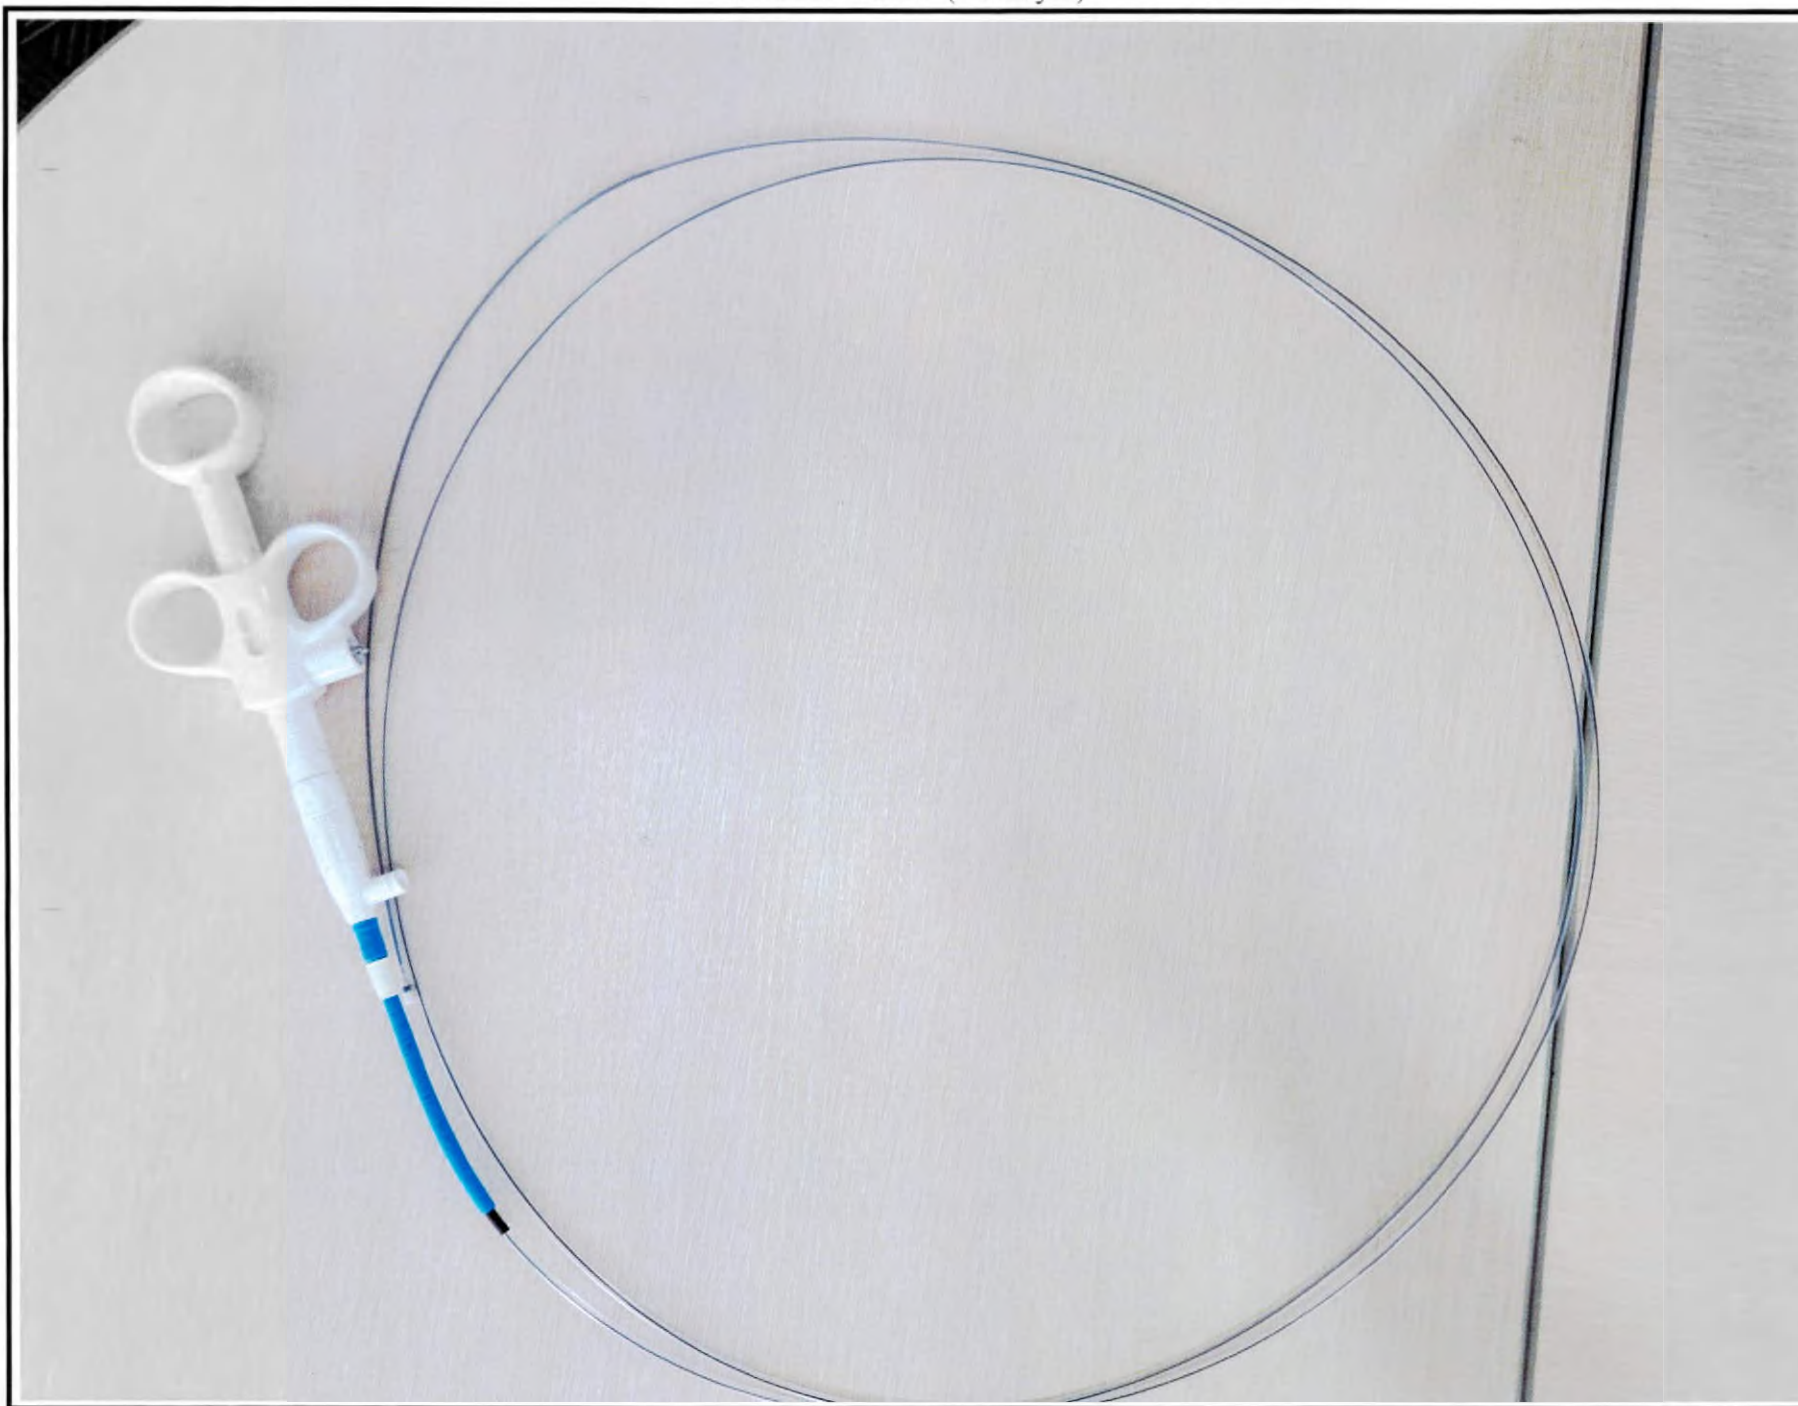

11. Пож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2620JI-B20- (1 шт./уп.) (Круглый тип)

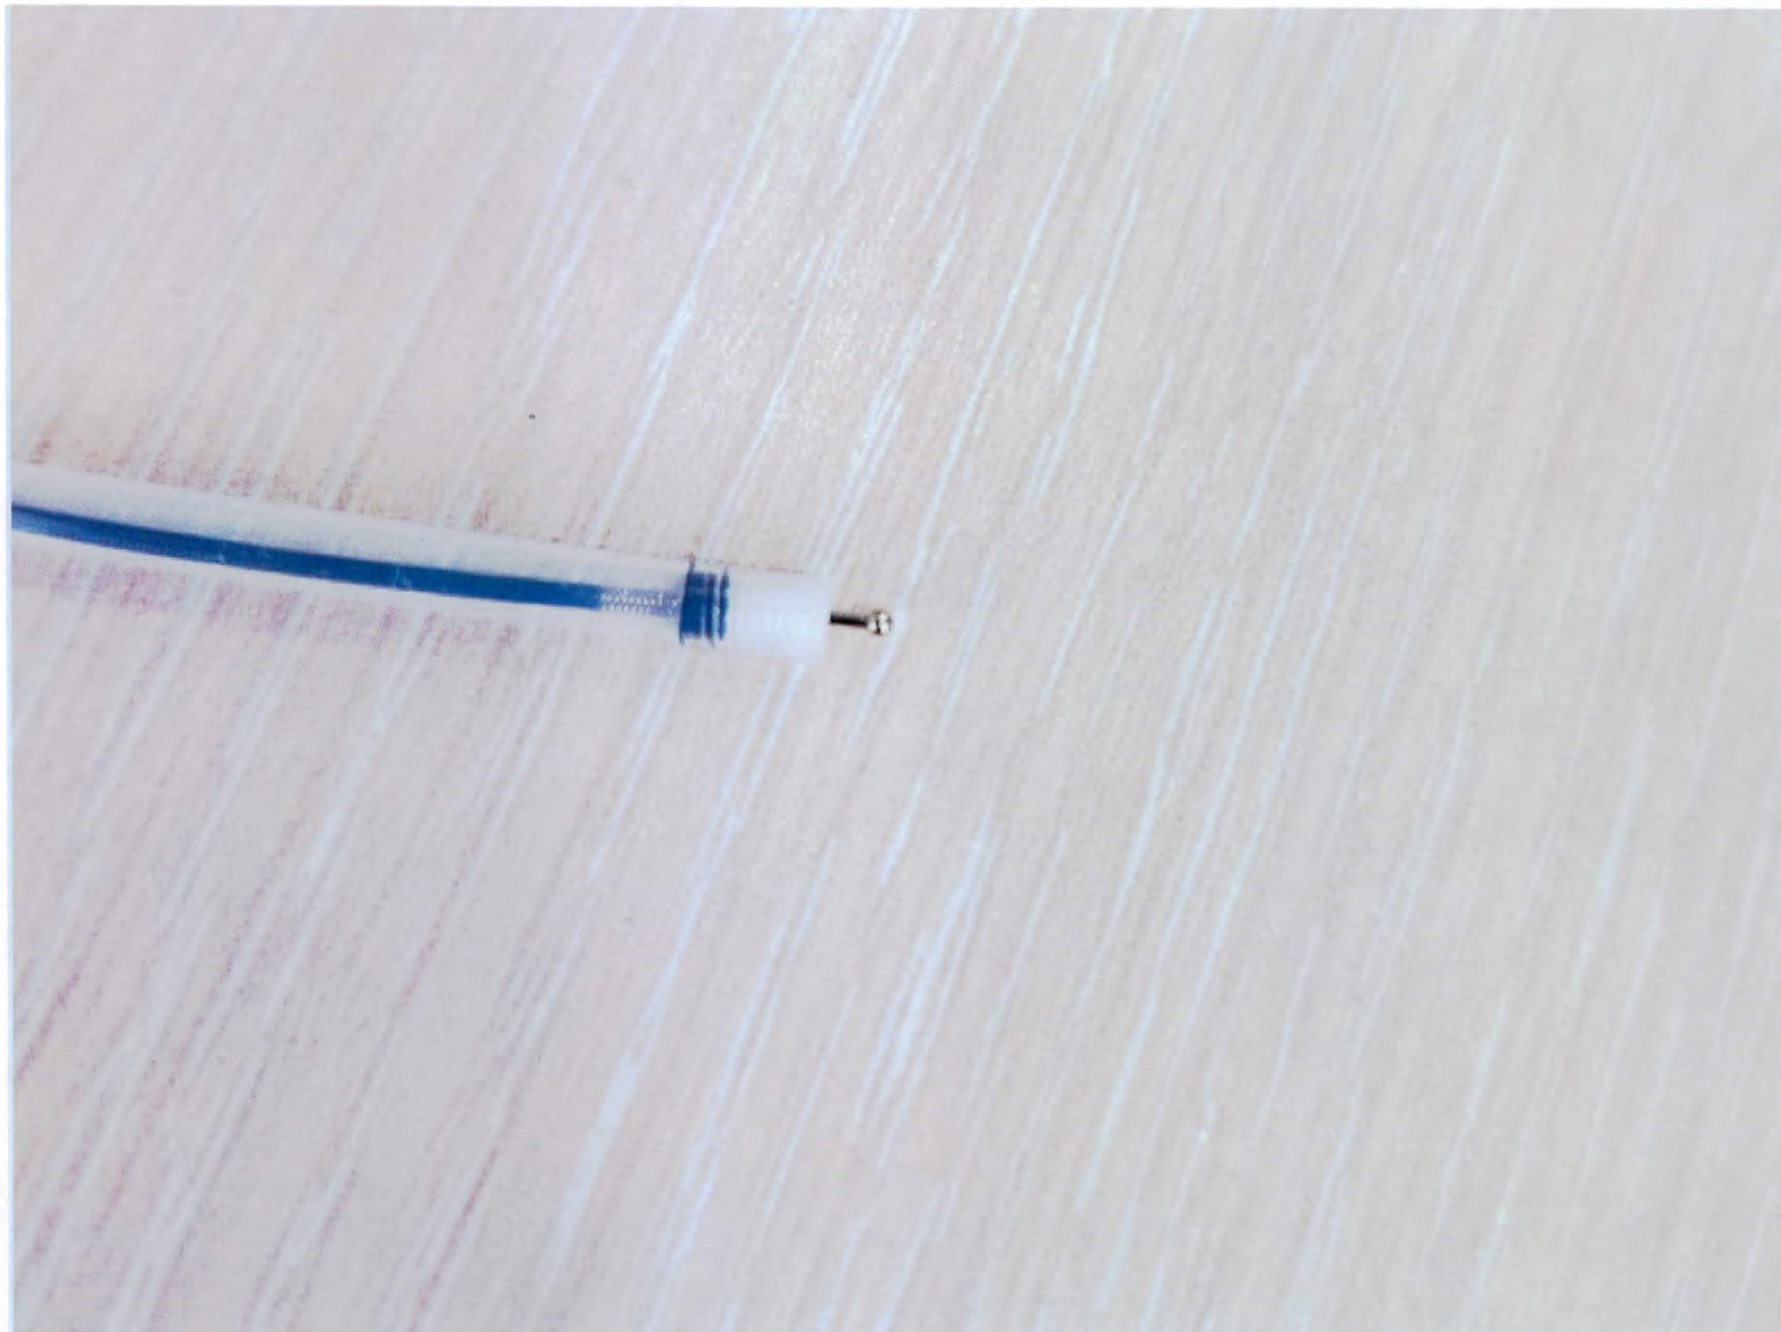

12. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2620JI-B25- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)


FUJIFILM

FT

FlushKnife BTs

DK2620JI -B25-


Diathermic Slitter



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥2.8mm

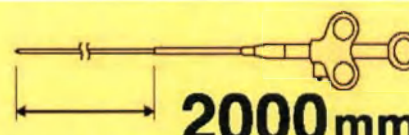

2000mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
de : Arbeitslänge : 2000mm
fr : Longueur utile : 2000mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
es : Longitud de trabajo : 2000mm
pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
nl : Werklengte : 2000mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm



STERILE EO



CE 0123



2018-03



2015-04

LOT

1504A1

MADE IN JAPAN

1504A1

GS1-128



(01) XXXXXXXXXXXXXXX (17) XXXXXX (10) XXXXXX


DK2620JI -B25- FF933A PI-1

405Y200886B

LN 20180331




12. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2620JI-B25- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)






DK2620JI -B25-

Diathermic Slitter





en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥ 2.8mm



2000mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
de : Arbeitslänge : 2000mm
fr : Longueur utile : 2000mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
es : Longitud de trabajo : 2000mm
pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
nl : Werklengte : 2000mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm








STERILE EO



CE 0123

 2018-03

 2015-04

LOT 1504A1

MADE IN JAPAN
1504A1


GS1-128




(01) XXXXXXXXXXXXX (17) XXXXXX (10) XXXXXX
DK2620JI -B25- FF933A PJ-0




12. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2620JI-B25- (1 шт./уп.)

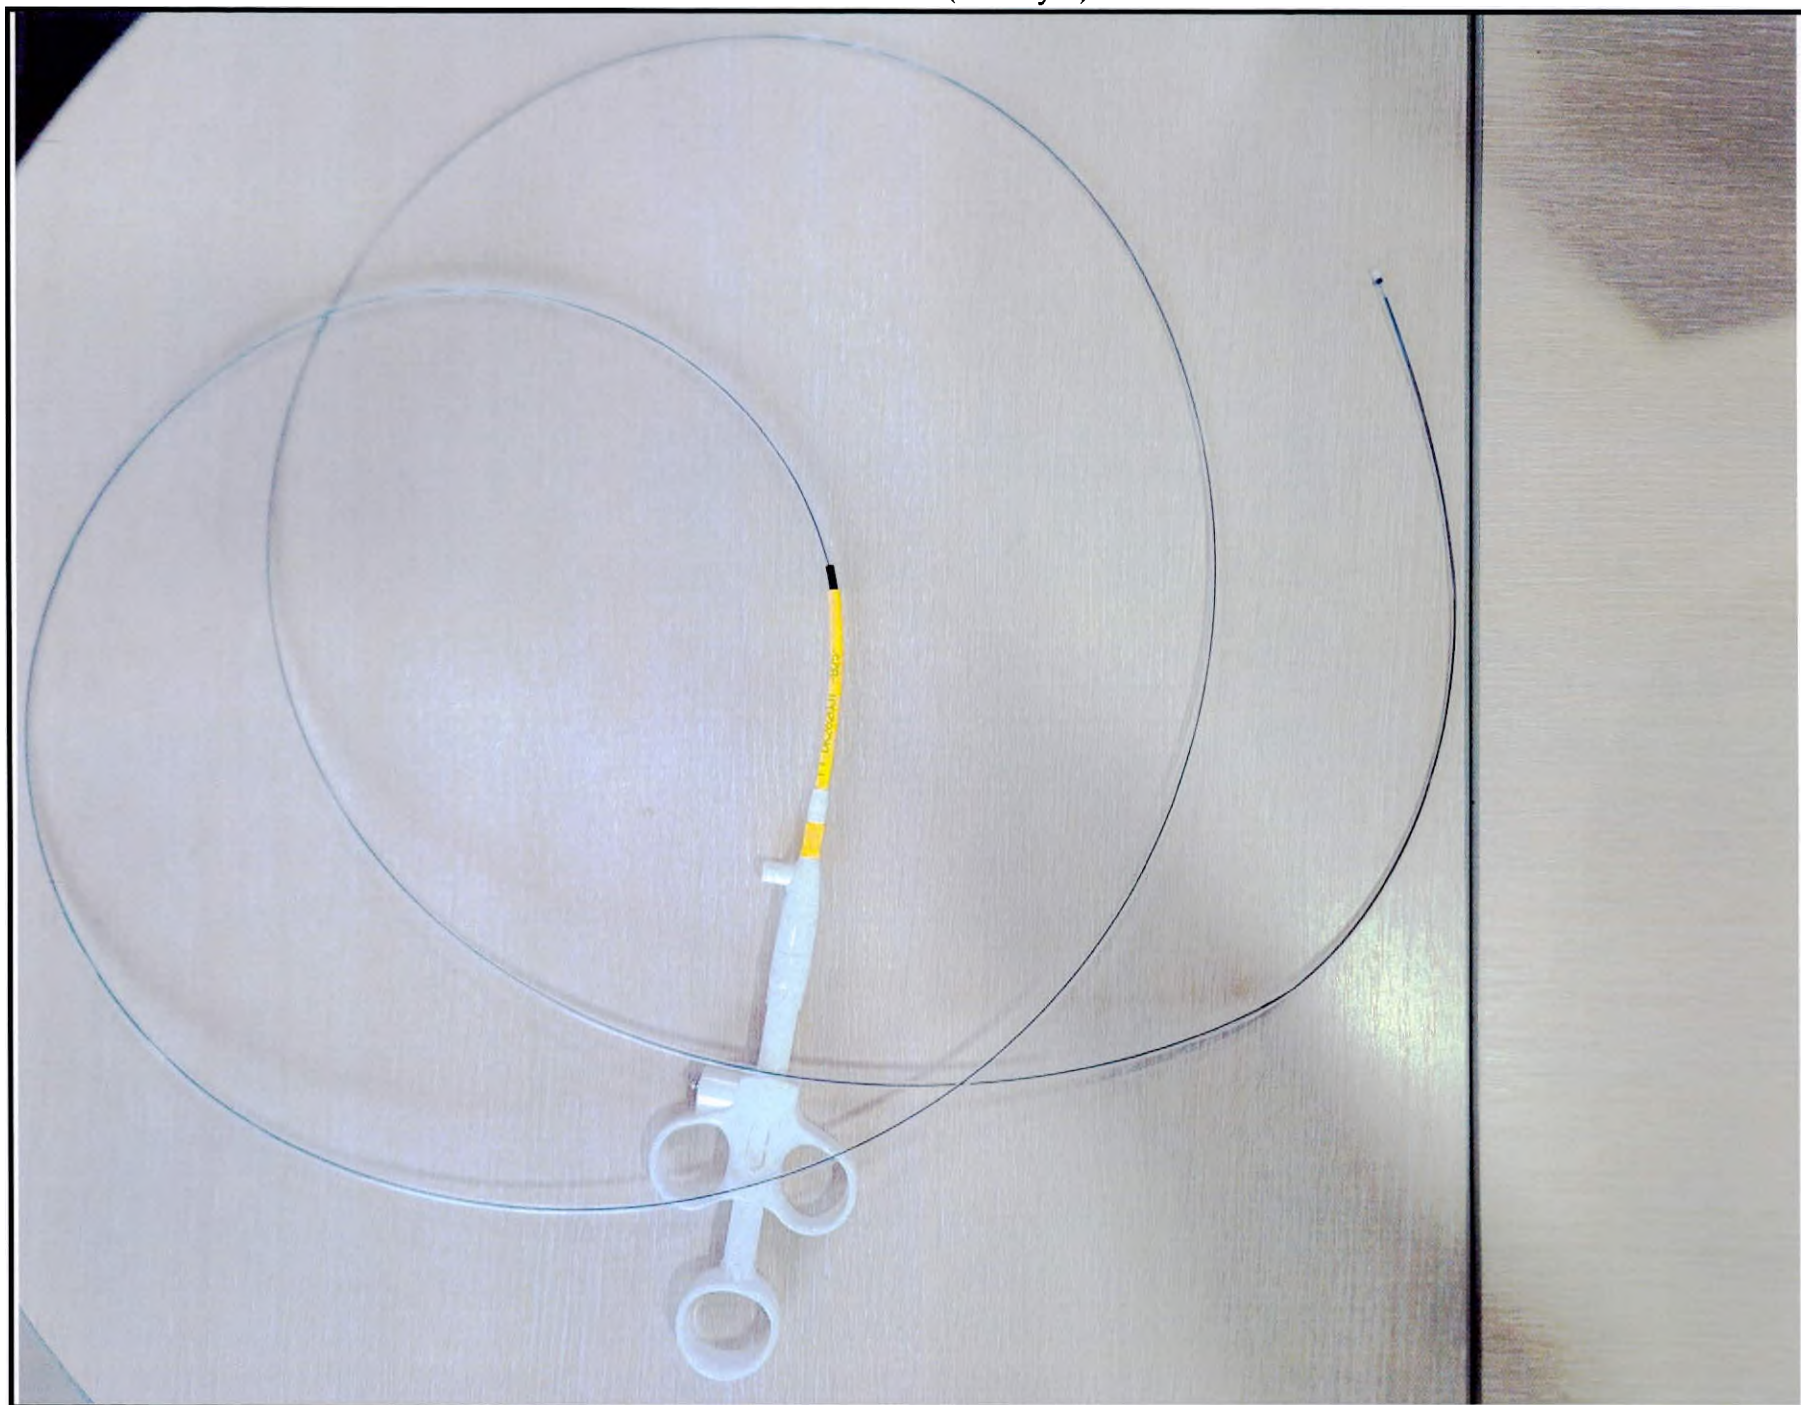

12. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2620JI-B25- (1 шт./уп.) (Круглый тип)

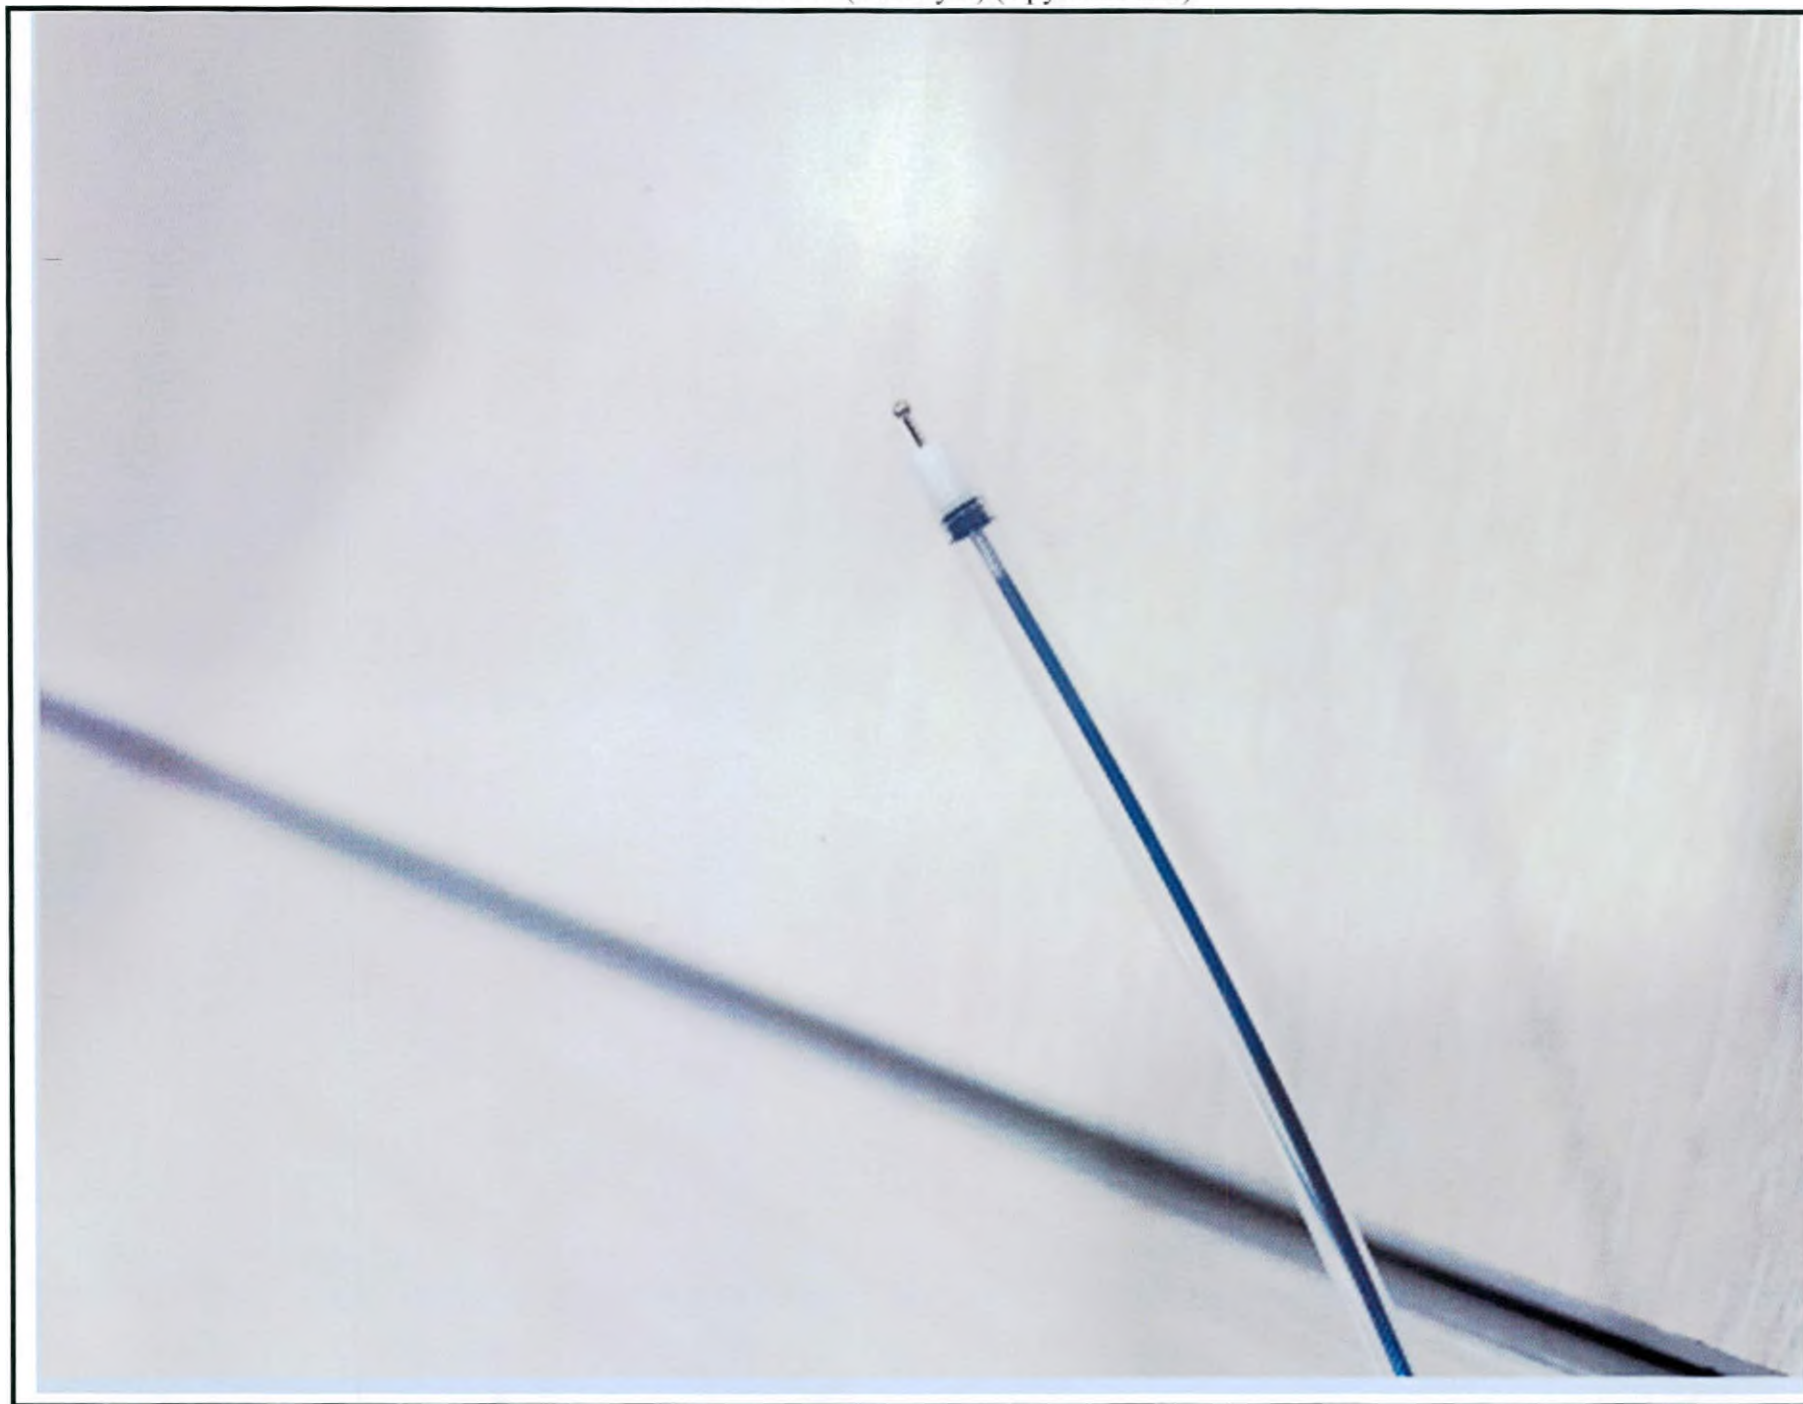


13. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2620JI-B30- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)






DK2620JI -B30-

Diathermic Slitter





en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturf diatérnico
pt : Cortador diatérnico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥2.8mm



2000mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
de : Arbeitslänge : 2000mm
fr : Longueur utile : 2000mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
es : Longitud de trabajo : 2000mm
pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
nl : Werklengte : 2000mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm







STERILE EO



CE 0123

2018-03

2015-04

LOT 1504A1

MADE IN JAPAN

1 pc.

GS1-128



(01) XXXXXXXXXXXX (17) XXXXXX (10) XXXXXX

DK2620JI -B30- FF934A PI-1

405Y200887B LN 20180331 1504A1

13. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, остановки кровотечения DK2620JI-B30- (1 шт./уп.) (общий вид упаковки/картонной коробки)

FUJIFILM

FlushKnife Bts **DK2620JI -B30-**

Diathermic Sitter

2.7mm 3.0mm

≥ 2.8mm 2000mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
 de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
 fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
 it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
 es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
 pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
 nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
 tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
 de : Arbeitslänge : 2000mm
 fr : Longueur utile : 2000mm
 it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
 es : Longitud de trabajo : 2000mm
 pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
 nl : Werklength : 2000mm
 tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm

1 pc.

GS1-128

(01)14547410375852(17)240800(10)2109T7

DK2620JI-B30- FF934A PJ-1

STERILE EO

CE 0123

2024-08

2021-10

LOT 2109T7

MADE IN JAPAN

2110B5

FUJIFILM Corporation
 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku
 Tokyo 106-8620, Japan

FUJIFILM Europe GmbH
 Heesenstrasse 31, 40549 Duesseldorf, Germany


EU Importer :
FUJIFILM Europe B.V.
 Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, The Netherlands

Imported to Australia by :
FUJIFILM Australia Pty Ltd
 114 Old Pittwater Road, Brookvale, NSW, 2100
 Australia

FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG
 Sumpfstrasse 13, 6312 Steinhausen, Switzerland

405N204J80A


13. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2620JI-B30- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)






DK2620JI -B30-

Diathermic Slitter





en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
de : Arbeitslänge : 2000mm
fr : Longueur utile : 2000mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
es : Longitud de trabajo : 2000mm
pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
nl : Werkleegte : 2000mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm











GS1-128



(01) XXXXXXXXXXXX (17) XXXXXX (10) XXXXXX
DK2620JI -B30- FF934A PI-0

STERILE EO

CE 0123

2018-03

2015-04


LOT 1504A1

MADE IN JAPAN
1504A1


13. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2620JI-B30- (1 шт./уп.) - стерильная упаковка



13. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2620JI-B30- (1 шт./уп.)

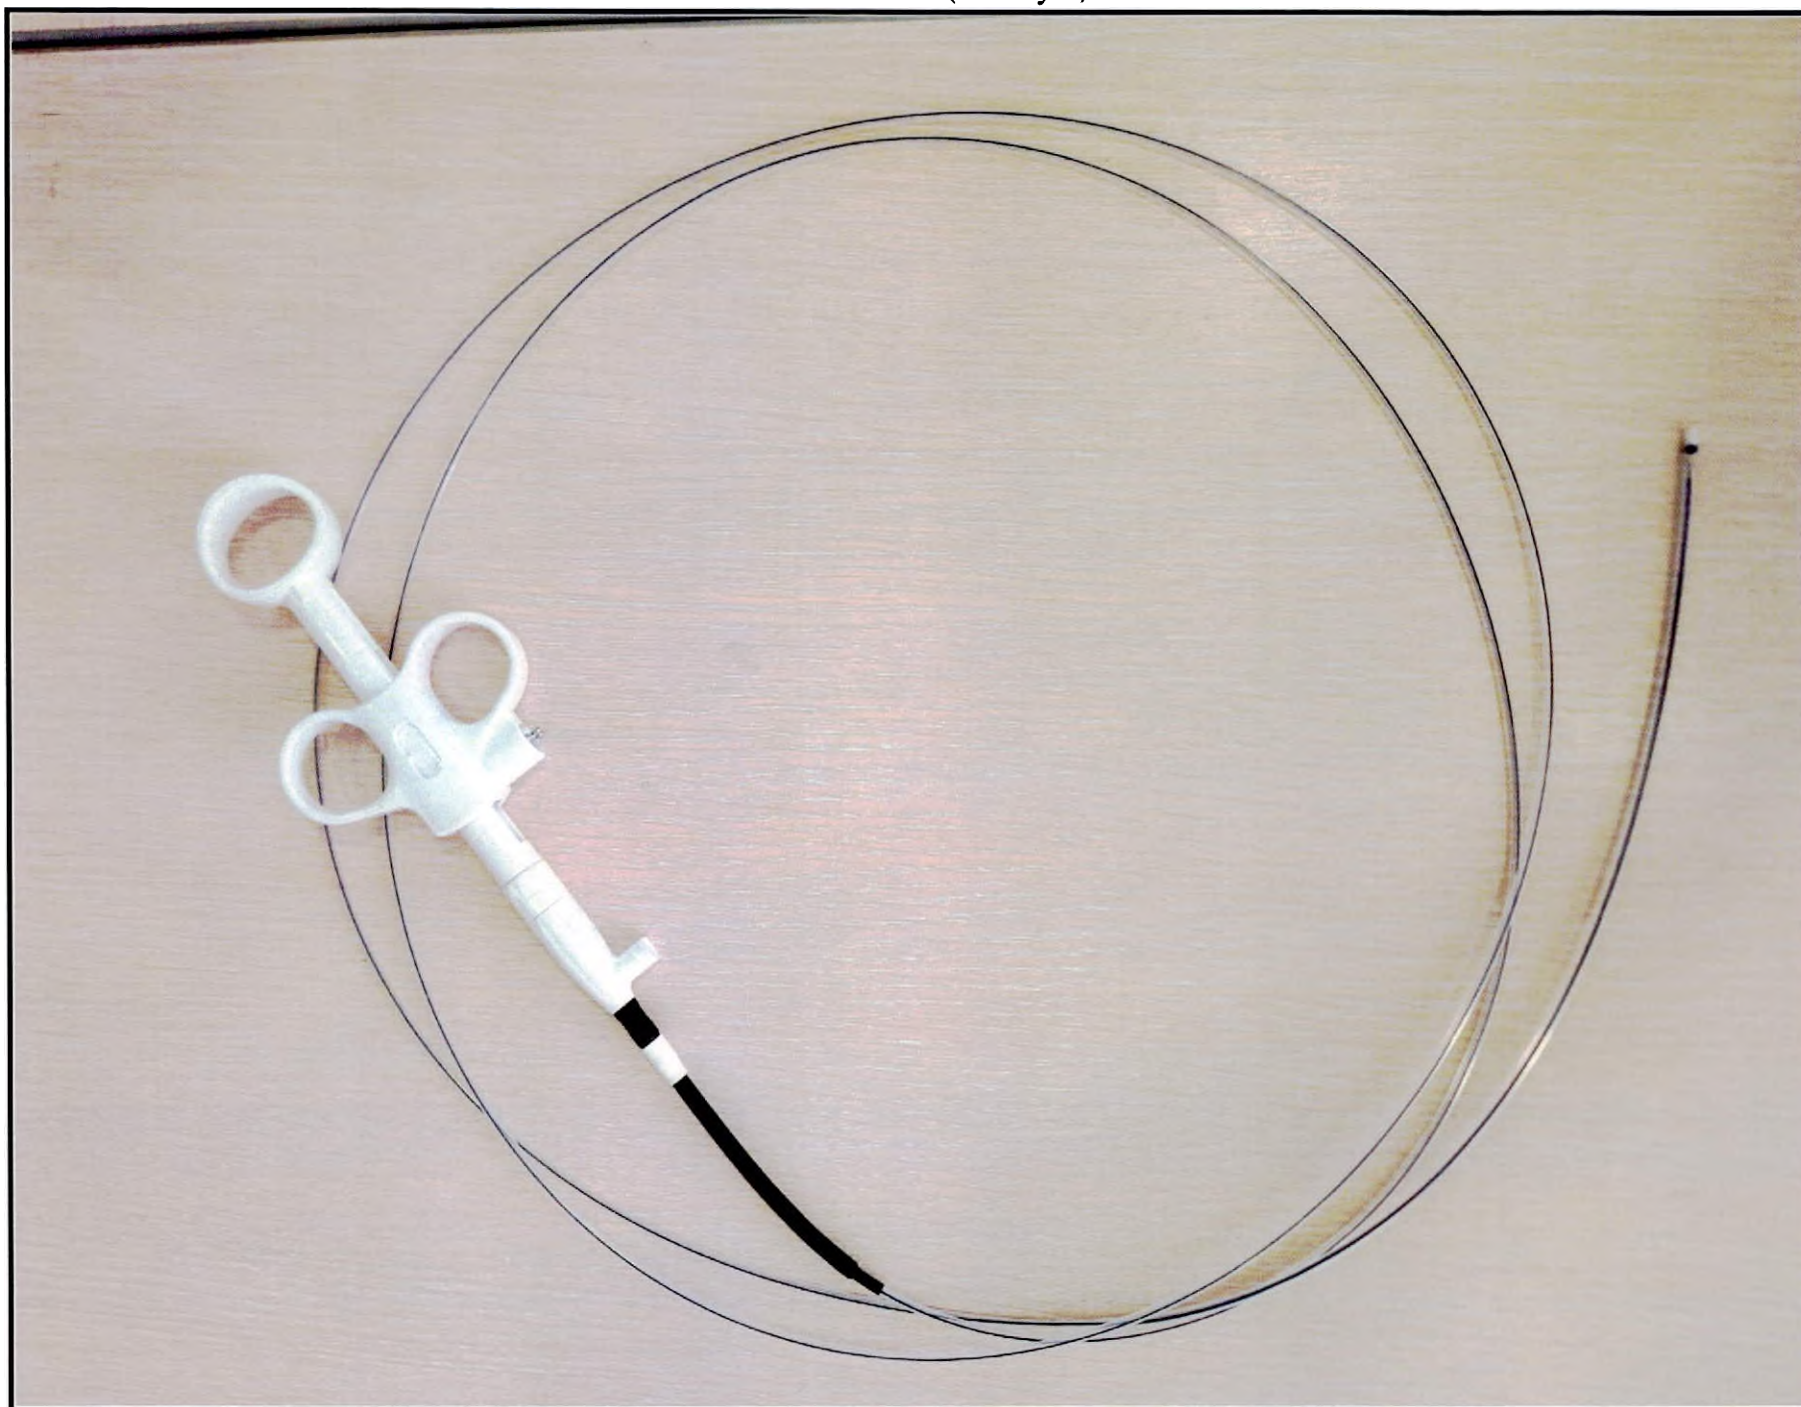

13. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2620JI-B30- (1 шт./уп.) (Круглый тип)

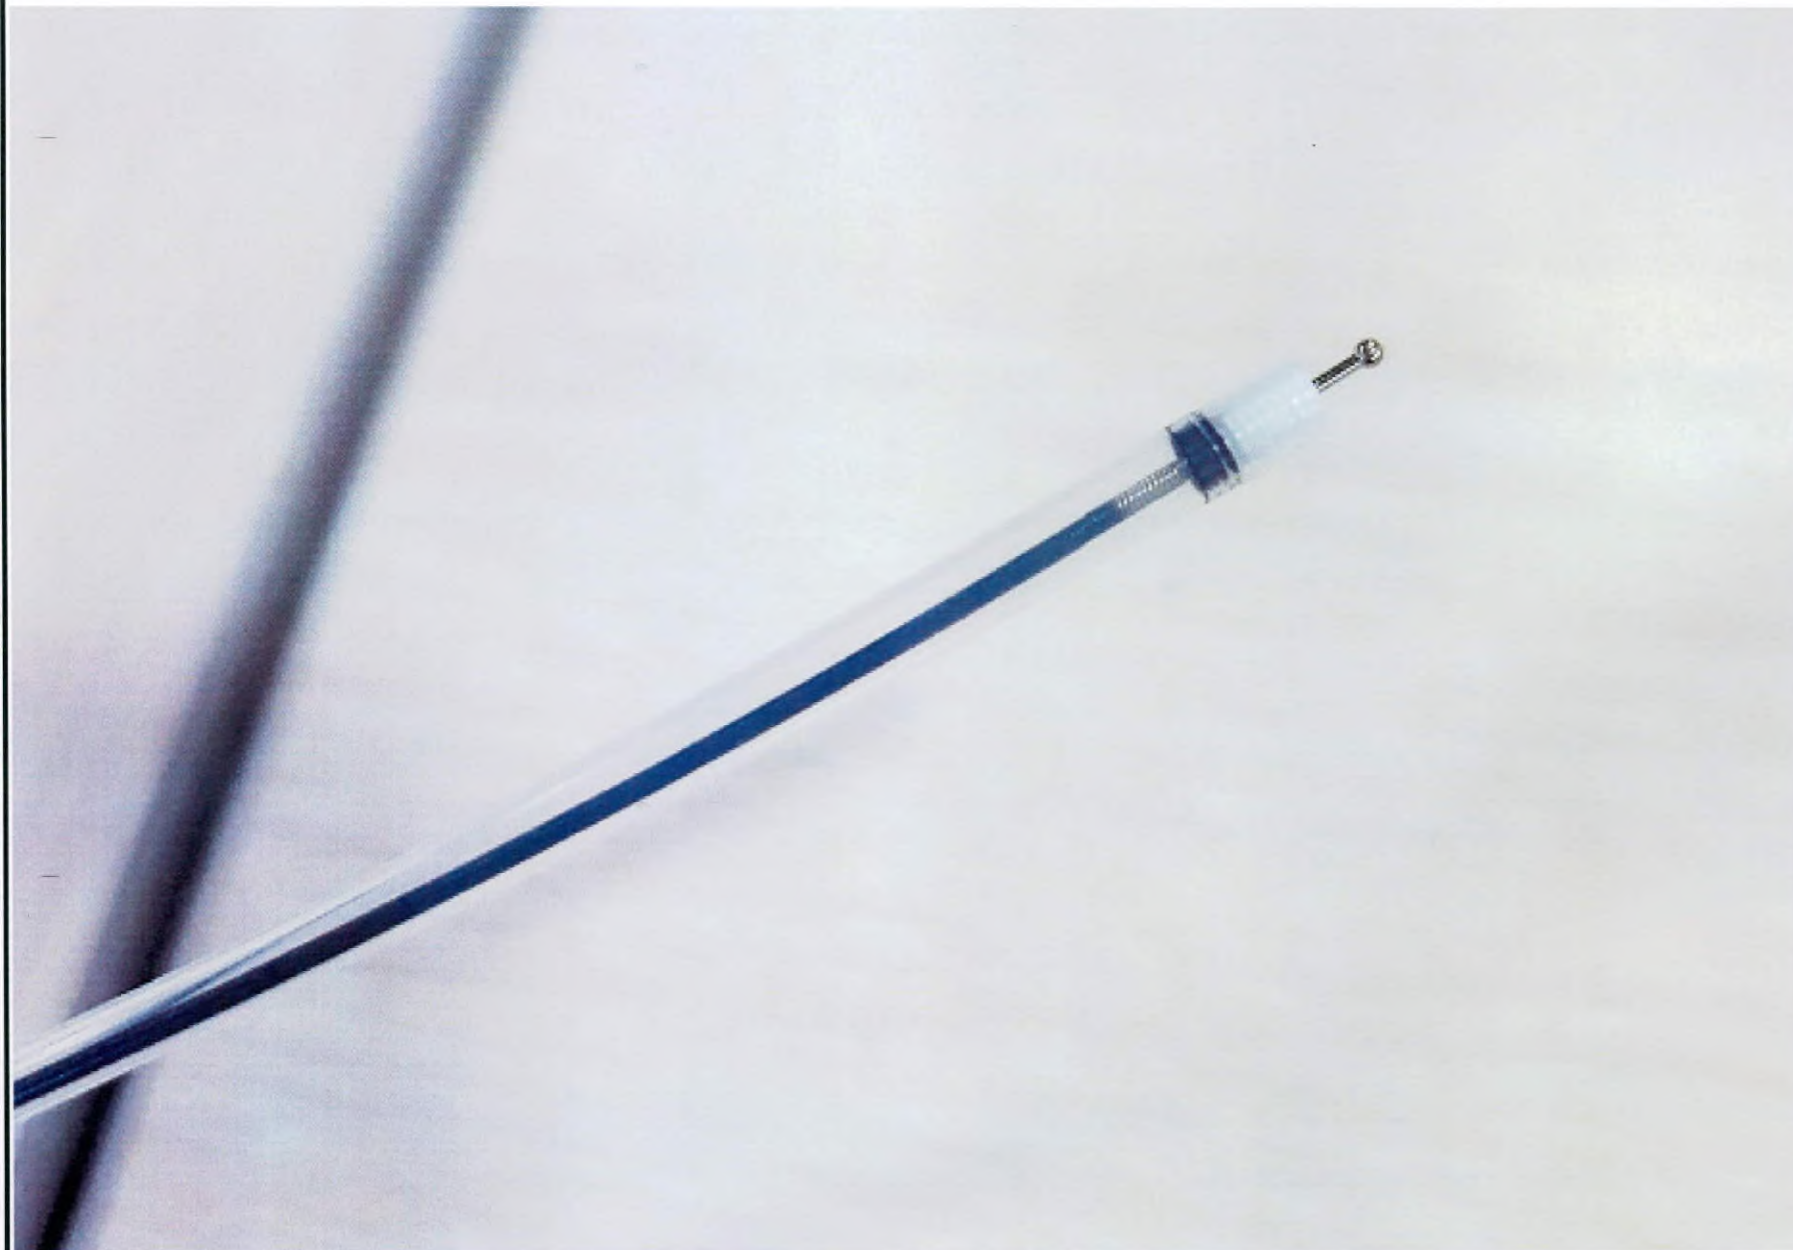


14. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N10- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)




FlushKnife Ns DK2620JI -N10-

Diathermic Slitter



2.7mm
1.0mm



en : Diathermic Slitter
 de : Diathermische Sonde
 fr : Couteau diathermique
 it : Bisturi diatermico
 es : Bisturí diatérmico
 pt : Cortador diatérmico
 nl : Diathermische snijmachine
 tr : Diyatermik Dilici



≥ 2.8mm




2000mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
 de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
 fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
 it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
 es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
 pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
 nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
 tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
 de : Arbeitslänge : 2000mm
 fr : Longueur utile : 2000mm
 it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
 es : Longitud de trabajo : 2000mm
 pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
 nl : Werklengte : 2000mm
 tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm






CE 0123

2018-03

2015-04

LOT 1504A1

MADE IN JAPAN

GS1-128



(01) XXXXXXXXXXXXX (17) XXXXXX (10) XXXXXX


DK2620JI -N10- FF926A PI-1

405Y200879B LN 20180331 1504A1


1 pc.

14. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N10- (1 шт./уп.)
(общий вид упаковки/картонной коробки)

FUJIFILM **FlushKnife Ns** **DK2620JI -N10-**
Diathermic Slicer




en : Diathermic Slicer
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturi diatermico
pt : Cortador diatermico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diatermik Dilci



en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
de : Arbeitslänge : 2000mm
fr : Longueur utile : 2000mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
es : Longitud de trabajo : 2000mm
pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
nl : Werk lengte : 2000mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm

1 pc.

GS1-128
0114547410375777(17)240600(10)2107T7
DK2620JI -N10- FF926A PI-1

STERILE EO

CE 0123

2024-06

2021-08

LOT 2107T7

MADE IN JAPAN

210688



FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku
Tokyo 106-8620, Japan



FUJIFILM Europe GmbH
Heesenstrasse 31, 40549 Duesseldorf, Germany

EU Importer :
FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, The Netherlands

Imported to Australia by :
FUJIFILM Australia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road, Brookvale, NSW. 2100
Australia



FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG
Sumpfstrasse 13, 6312 Steinhausen, Switzerland


405N204380A

14. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N10- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)




FlushKnife **Ns** DK2620JI -N10-

Diathermic Slitter





en : Diathermic Slitter
 de : Diathermische Sonde
 fr : Couteau diathermique
 it : Bisturi diatermico
 es : Bisturi diatérmico
 pt : Cortador diatérmico
 nl : Diathermische snijmachine
 tr : Diyatermik Dilici



≥2.8mm



2000mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
 de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
 fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
 it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
 es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
 pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
 nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
 tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
 de : Arbeitslänge : 2000mm
 fr : Longueur utile : 2000mm
 it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
 es : Longitud de trabajo : 2000mm
 pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
 nl : Werklengte : 2000mm
 tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm











GS1-128



(01) XXXXXXXXXXXXX (17) XXXXXX (10) XXXXXX
 DK2620JI -N10- FF828A PI-0

STERILE EO

CE 0123

2018-03

2015-04


LOT 1504A1

MADE IN JAPAN
1504A1


14. Нож для абляции, надреза, и сечения ткани DK2620JI-N10- (1 шт./уп.) - стерильная упаковка




14. Пиж для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N10- (1 шт./уп.)

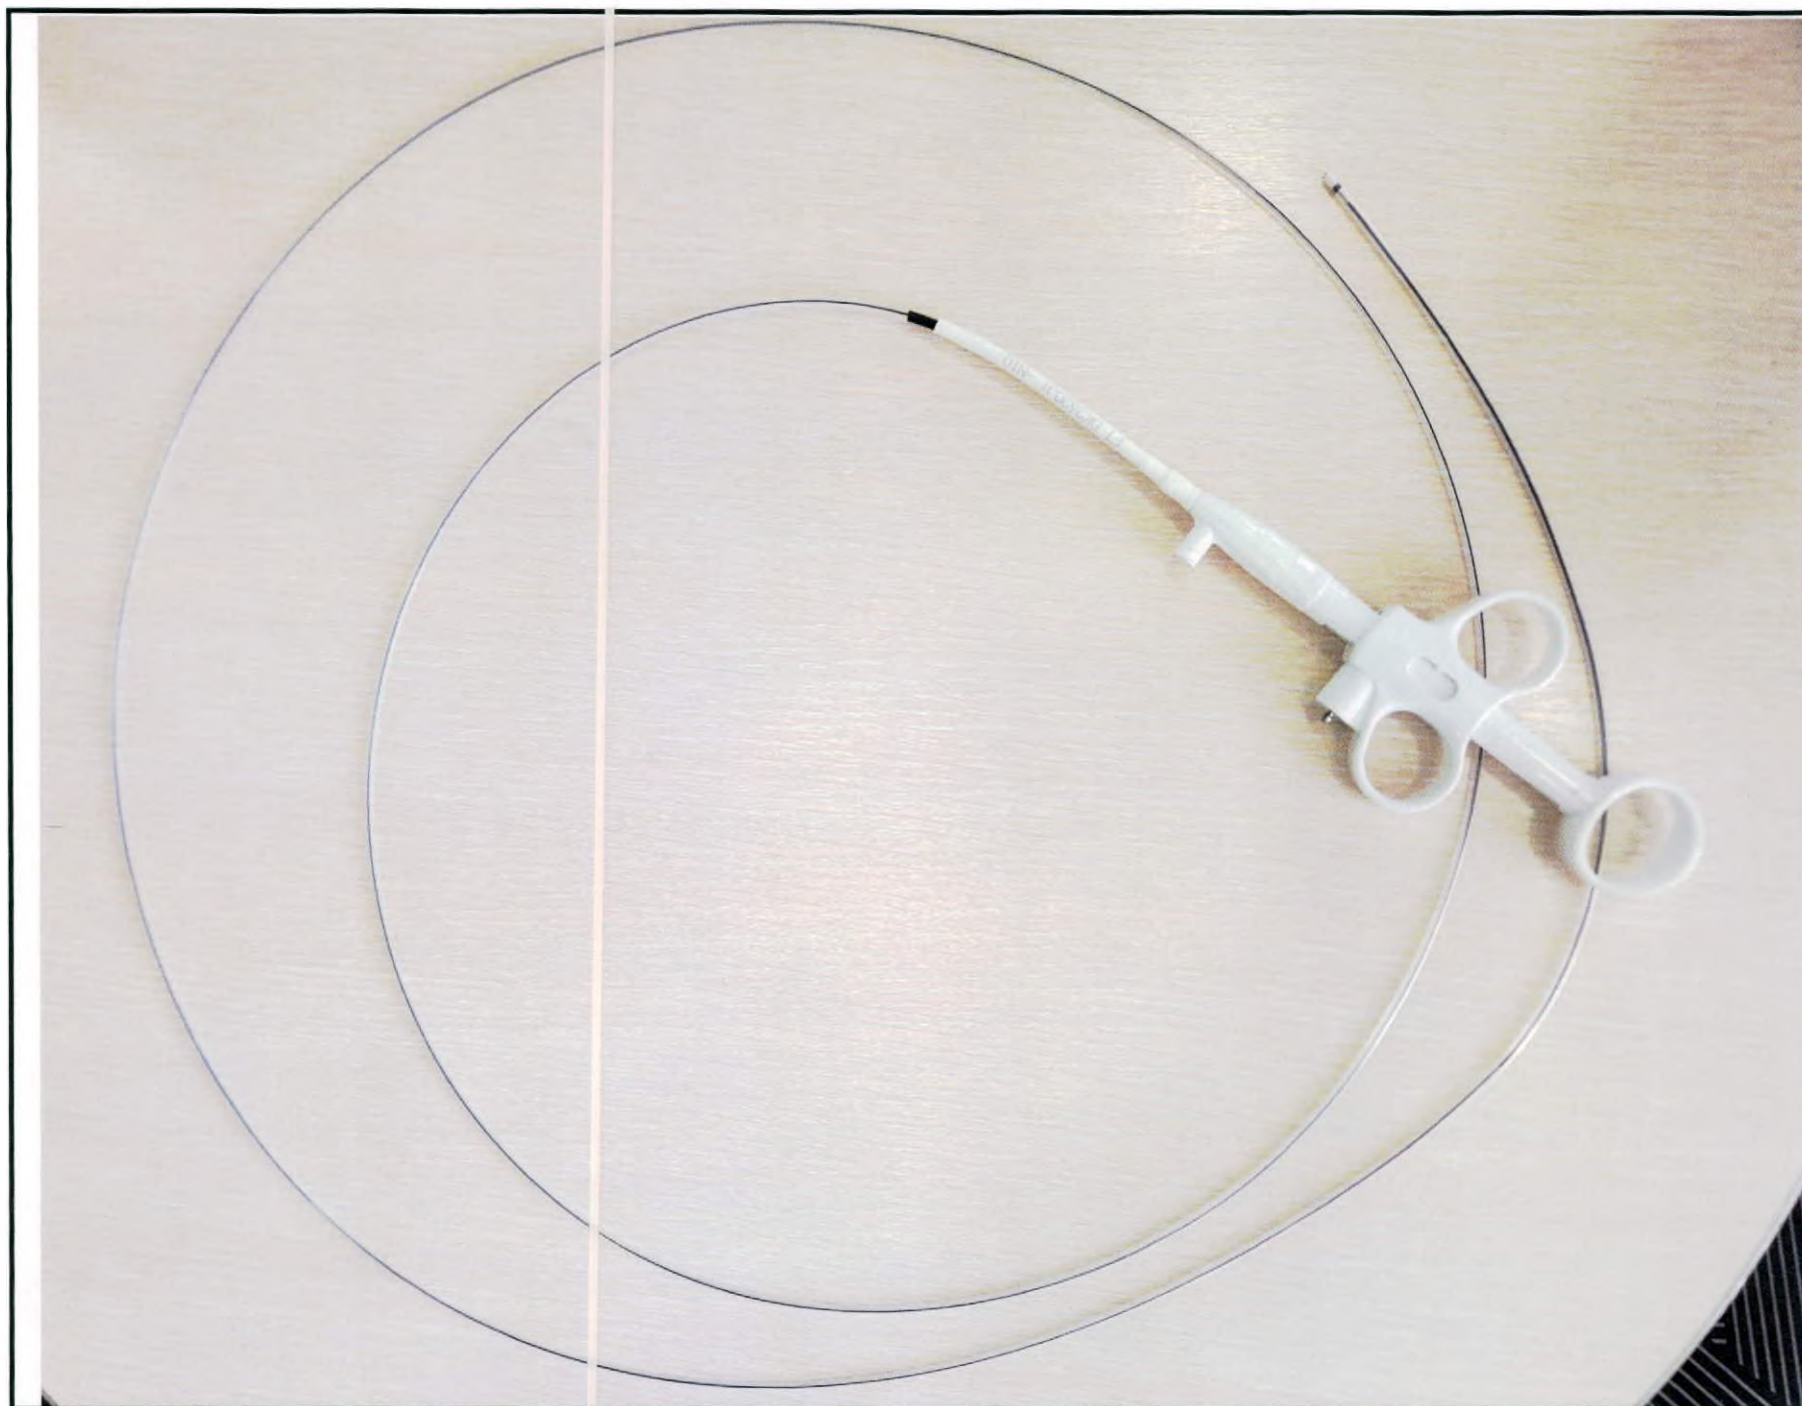

14. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N10- (1 шт./уп.) (Игольчатый тип)

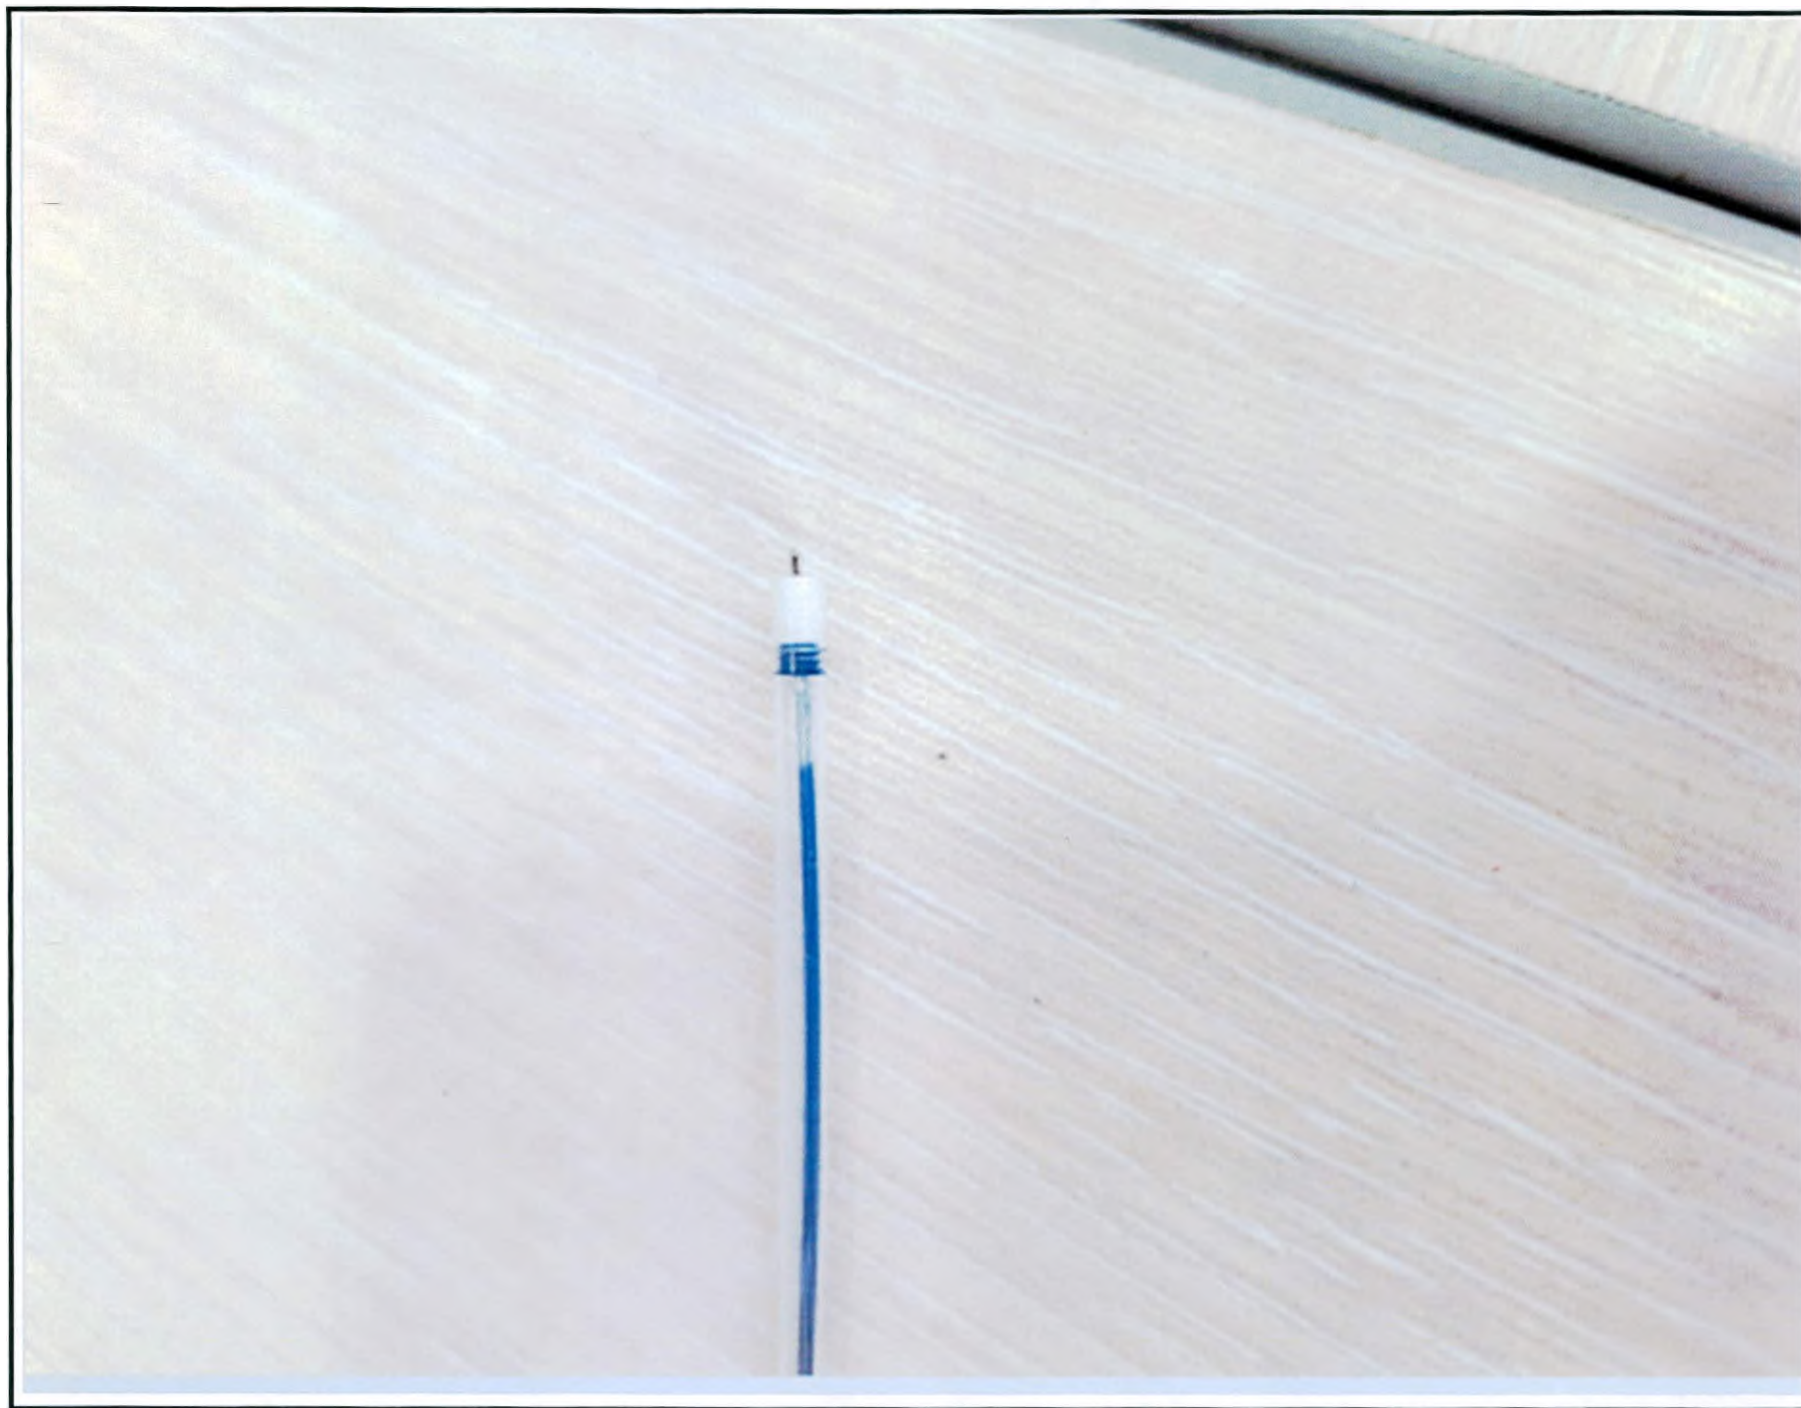


15. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N15- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)




FlushKnife **Ns** DK2620JI -N15-

Diathermic Slitter





en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturf diatémico
pt : Cortador diatémico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥ 2.8mm



2000mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
de : Arbeitslänge : 2000mm
fr : Longueur utile : 2000mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
es : Longitud de trabajo : 2000mm
pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
nl : Werklength : 2000mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm









1 pc.

GS1-128



(01) XXXXXXXXXXXXX (17) XXXXXX (10) XXXXXX
DK2620JI -N15- FF927A PI-1

405Y200880B LN 20180331

STERILE EO

CE 0123

2018-03

2015-04


LOT 1504A1

MADE IN JAPAN
1504A1

15. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N15- (1 шт./уп.)

(общий вид упаковки/картонной коробки)

FUJIFILM
FlushKnife Ns DK2620JI -N15-
 Diathermic Scissors

en: Maximum diameter of insertion portion: 2.7mm
 de: Maximaler Durchmesser des Einführteils: 2.7mm
 fr: Diamètre maximum de la partie à insérer: 2.7mm
 it: Diametro massimo della sezione di inserimento: 2.7mm
 es: Diámetro máximo de la parte de inserción: 2.7mm
 pt: Diâmetro máximo da parte de inserção: 2.7mm
 nl: Maximale diameter van inbrengdeel: 2.7mm
 tr: Takma kısmının maksimum çapı: 2.7mm

en: Working Length: 2000mm
 de: Arbeitslänge: 2000mm
 fr: Longueur utile: 2000mm
 it: Lunghezza utile di lavoro: 2000mm
 es: Longitud de trabajo: 2000mm
 pt: Comprimento de trabalho: 2000mm
 nl: Werk lengte: 2000mm
 tr: Çalışma uzunluğu: 2000mm

1 pc.

GS1-128
 (01)14547410375784(17)240700(10)2108S5
 DK2620JI -N15- FF927A P1-1

STERILE EO
 CE 0123
 2024-07
 2021-08
 LOT 2108S5
 MADE IN JAPAN
 210803

FUJIFILM Corporation
 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku
 Tokyo 106-8620, Japan

FUJIFILM Europe GmbH
 Heesenstrasse 31, 40549 Duesseldorf, Germany

EU Importer:
FUJIFILM Europe B.V.
 Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, The Netherlands

Imported to Australia by:
FUJIFILM Australia Pty Ltd
 114 Old Pittwater Road, Brookvale, NSW, 2100
 Australia

FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG
 Sumpfstrasse 13, 6312 Steinhausen, Switzerland

405N204380A

15. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N15- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)


FUJIFILM

FT

FlushKnife **Ns**

DK2620JI -N15-


Diathermic Slitter



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥2.8mm

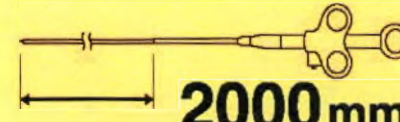

2000mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
de : Arbeitslänge : 2000mm
fr : Longueur utile : 2000mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
es : Longitud de trabajo : 2000mm
pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
nl : Werkleugte : 2000mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm



STERILE EO

CE 0123

2018-03

2015-04

LOT 1504A1

MADE IN JAPAN
1504A1

GS1-128




(01) XXXXXXXXXX (17) XXXXXX (10) XXXXXX


DK2620JI -N15- FF927A PI-0




15. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N15- (1 шт./уп.)

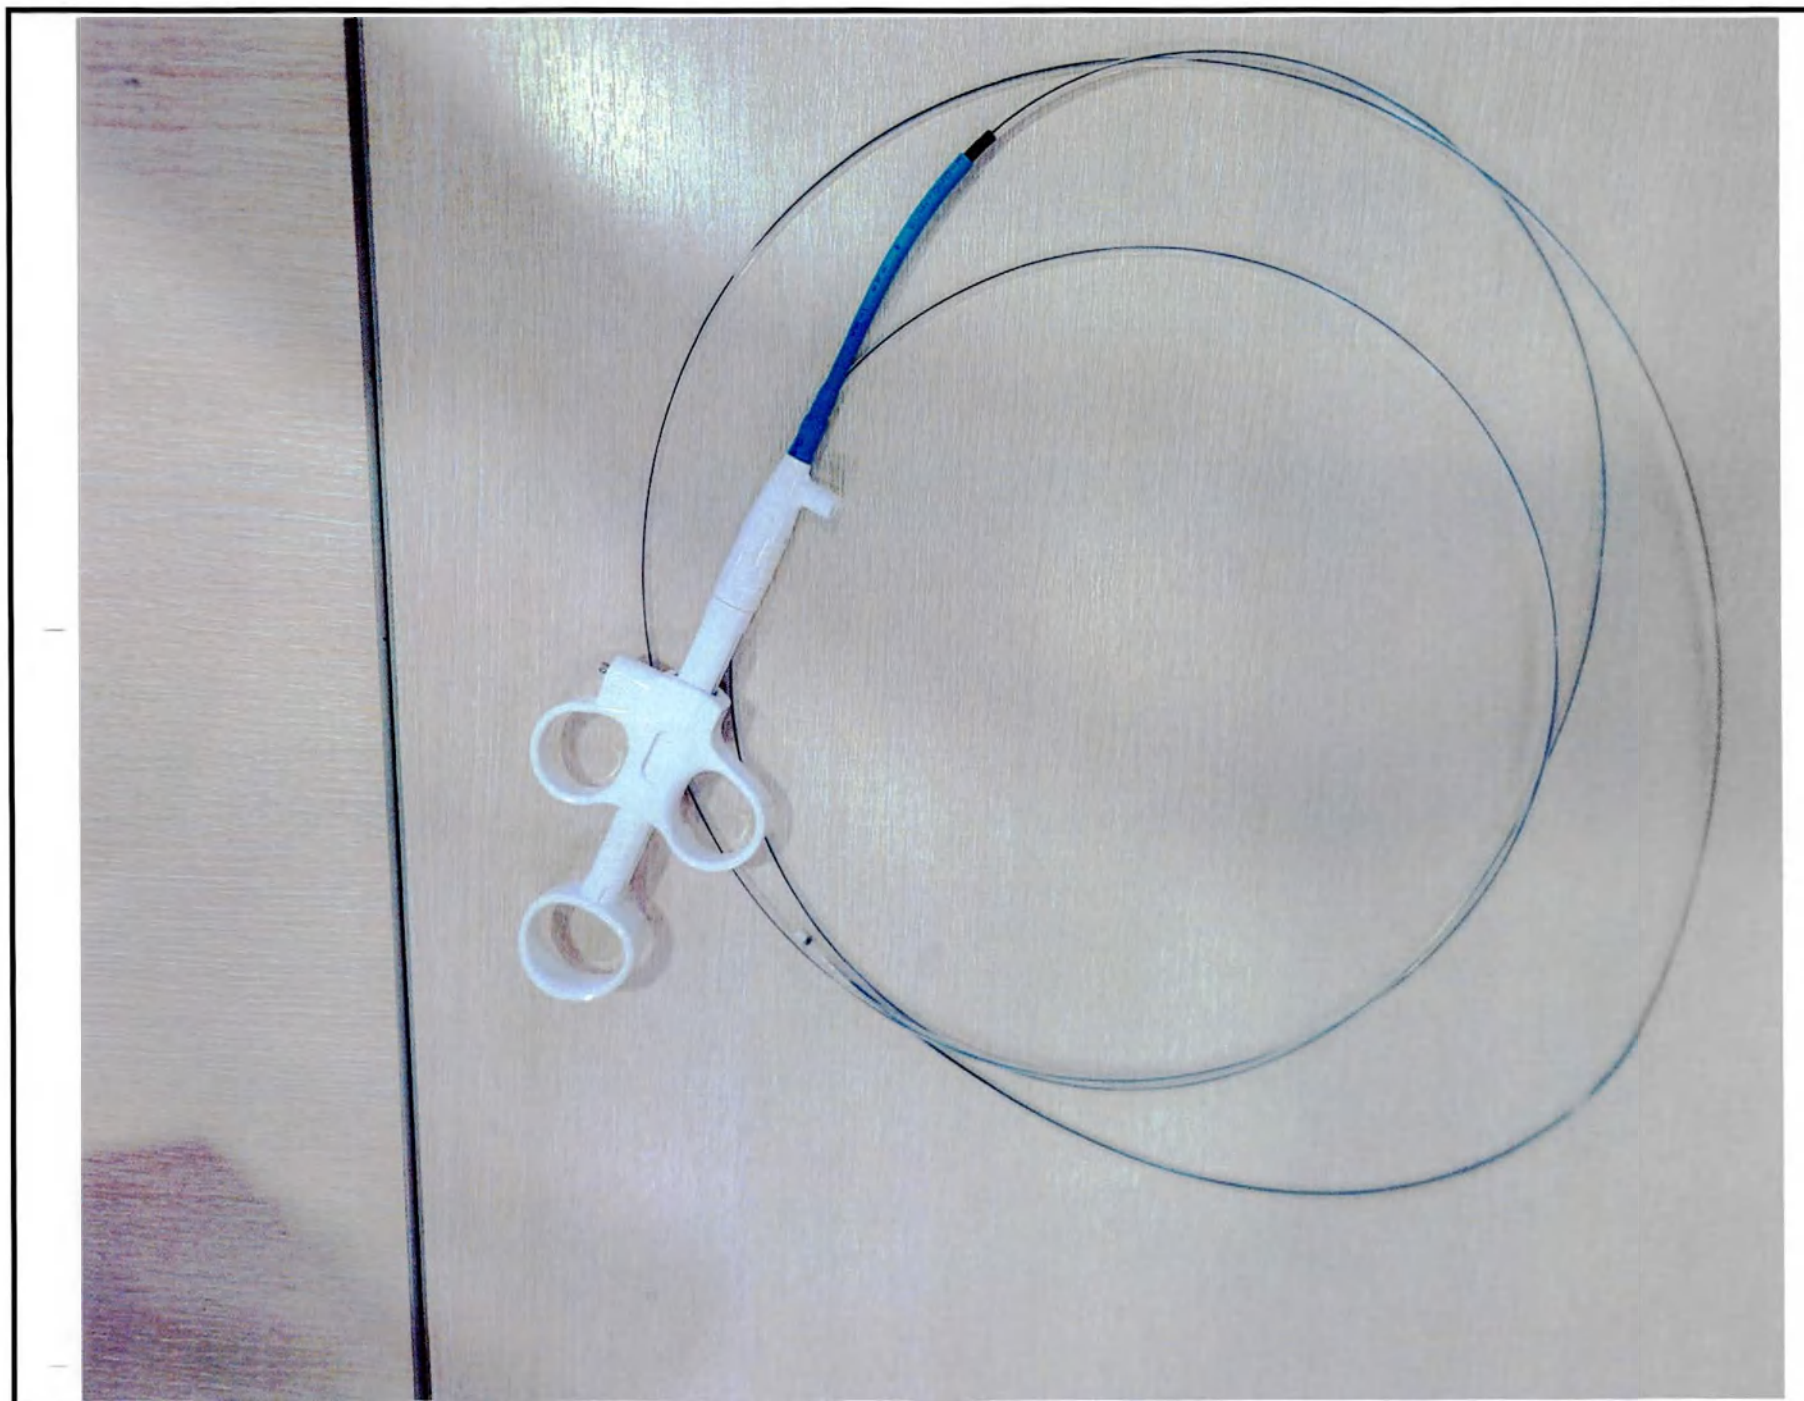

15. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N15- (1 шт./уп.) (Игольчатый тип)

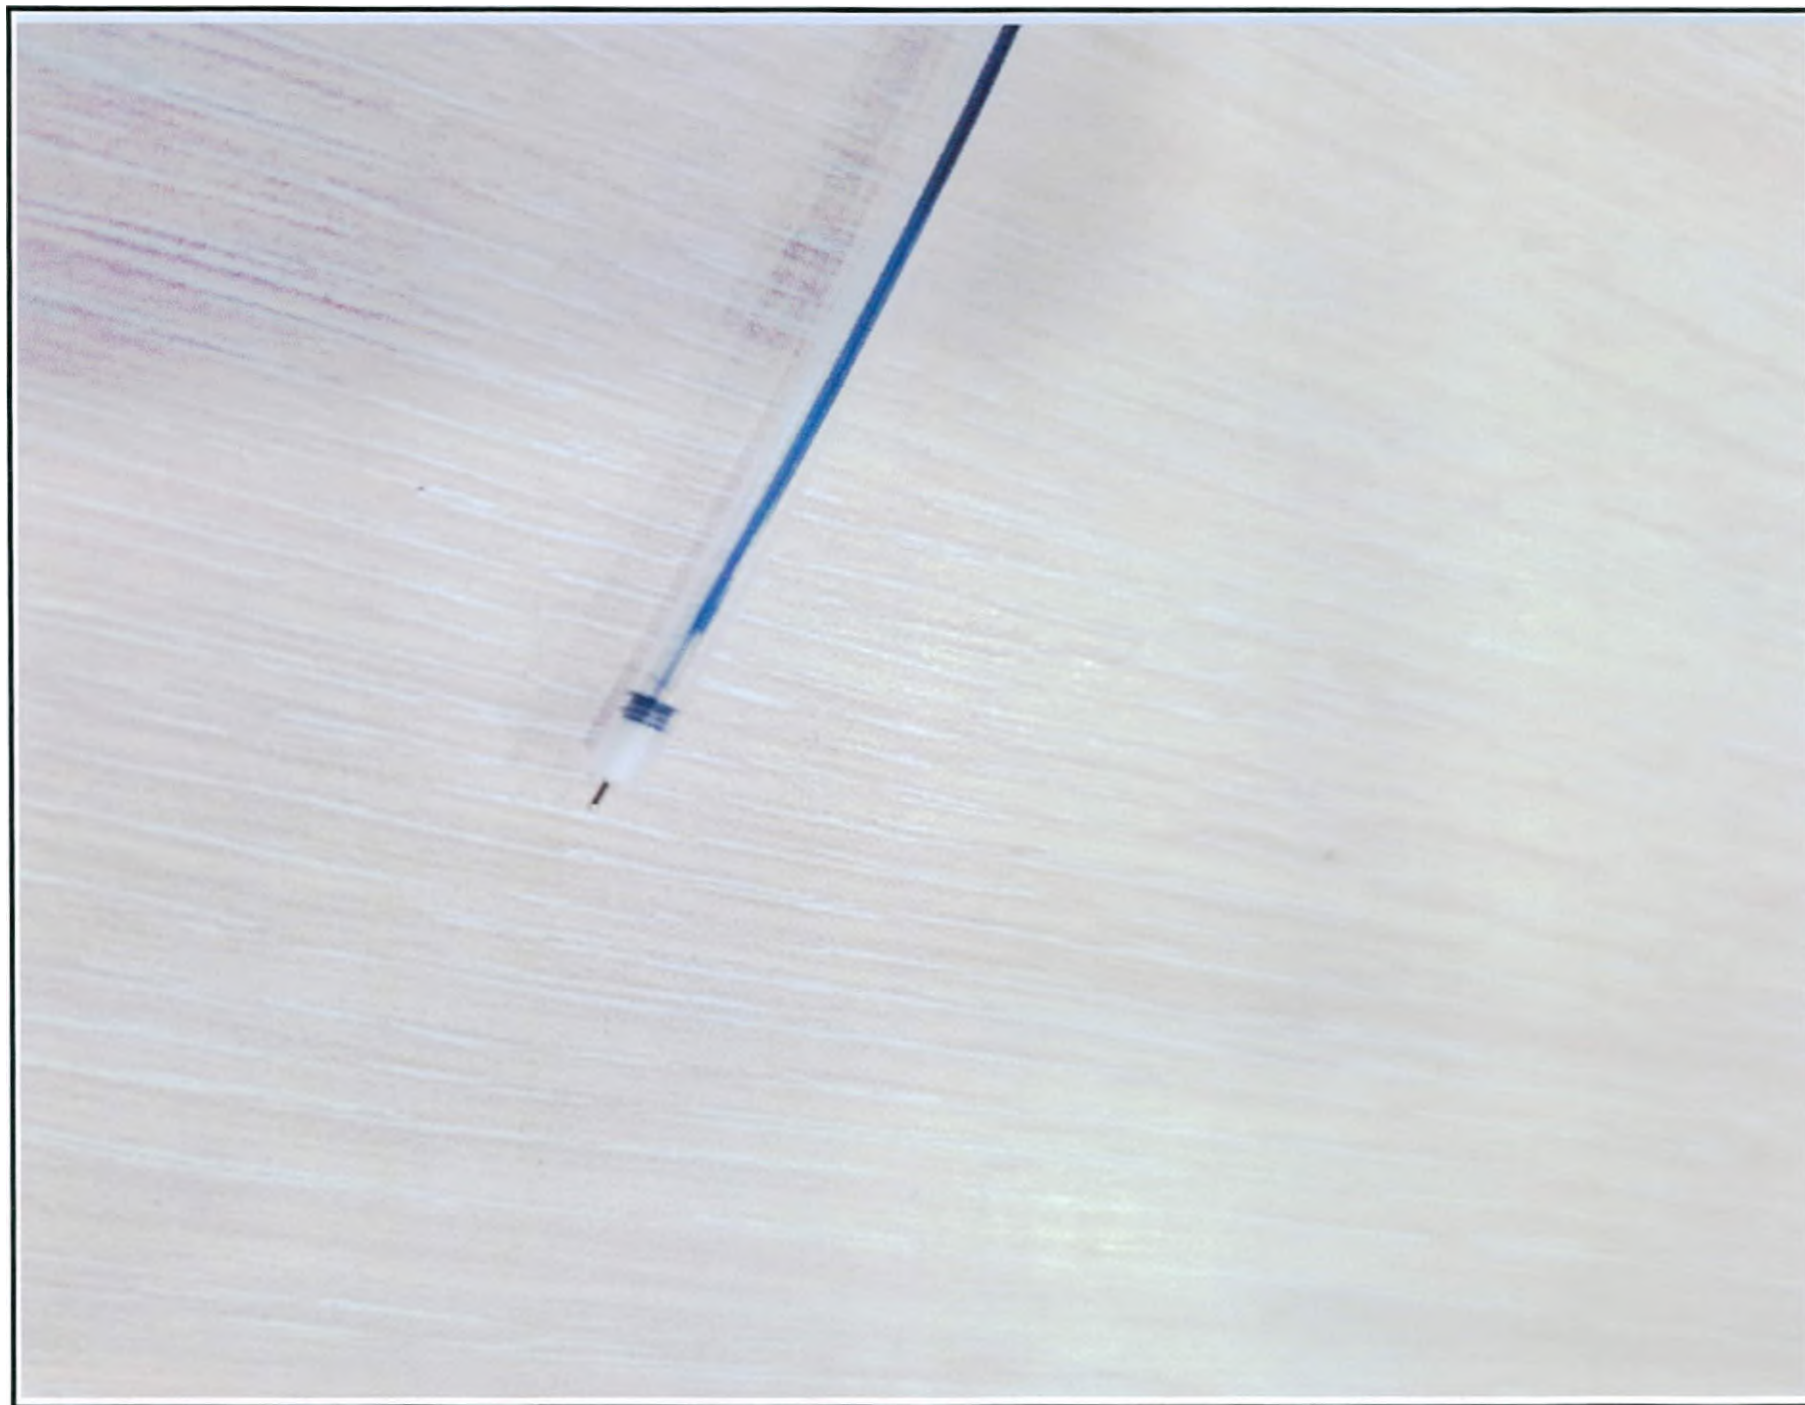


16. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N20- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)




FlushKnife **Ns** DK2620JI -N20-

Diathermic Slitter





en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturf diatèrmico
pt : Cortador diatèrmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥ 2.8mm



2000mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
de : Arbeitslänge : 2000mm
fr : Longueur utile : 2000mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
es : Longitud de trabajo : 2000mm
pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
nl : Werklengte : 2000mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm











1 pc.

GS1-128



(01) XXXXXXXXXXXXX (17) XXXXXX (10) XXXXXX

DK2620JI -N20- FF928A PI-1

405Y200881B LN 20180331

CE 0123

2018-03

2015-04

LOT 1504A1

MADE IN JAPAN

1504A1

16. Пож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N20- (1 шт./уп.)

(общий вид упаковки/картонной коробки)



16. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N20- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)


FUJIFILM

(FT)

FlushKnife **Ns**

DK2620JI -N20-


Diathermic Slitter



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥ 2.8mm

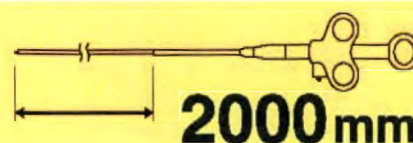

2000mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
de : Arbeitslänge : 2000mm
fr : Longueur utile : 2000mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
es : Longitud de trabajo : 2000mm
pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
nl : Werklengte : 2000mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm



STERILE EO



CE 0123

2018-03

2015-04

LOT 1504A1

MADE IN JAPAN
1504A1

GS1-128




(01) XXXXXXXXXXXXX (17) XXXXXX (10) XXXXXX

DK2620JI -N20- FF928A PI-0


16. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N20- (1 шт./уп.) - стерильная упаковка



16. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N20- (1 шт./уп.)

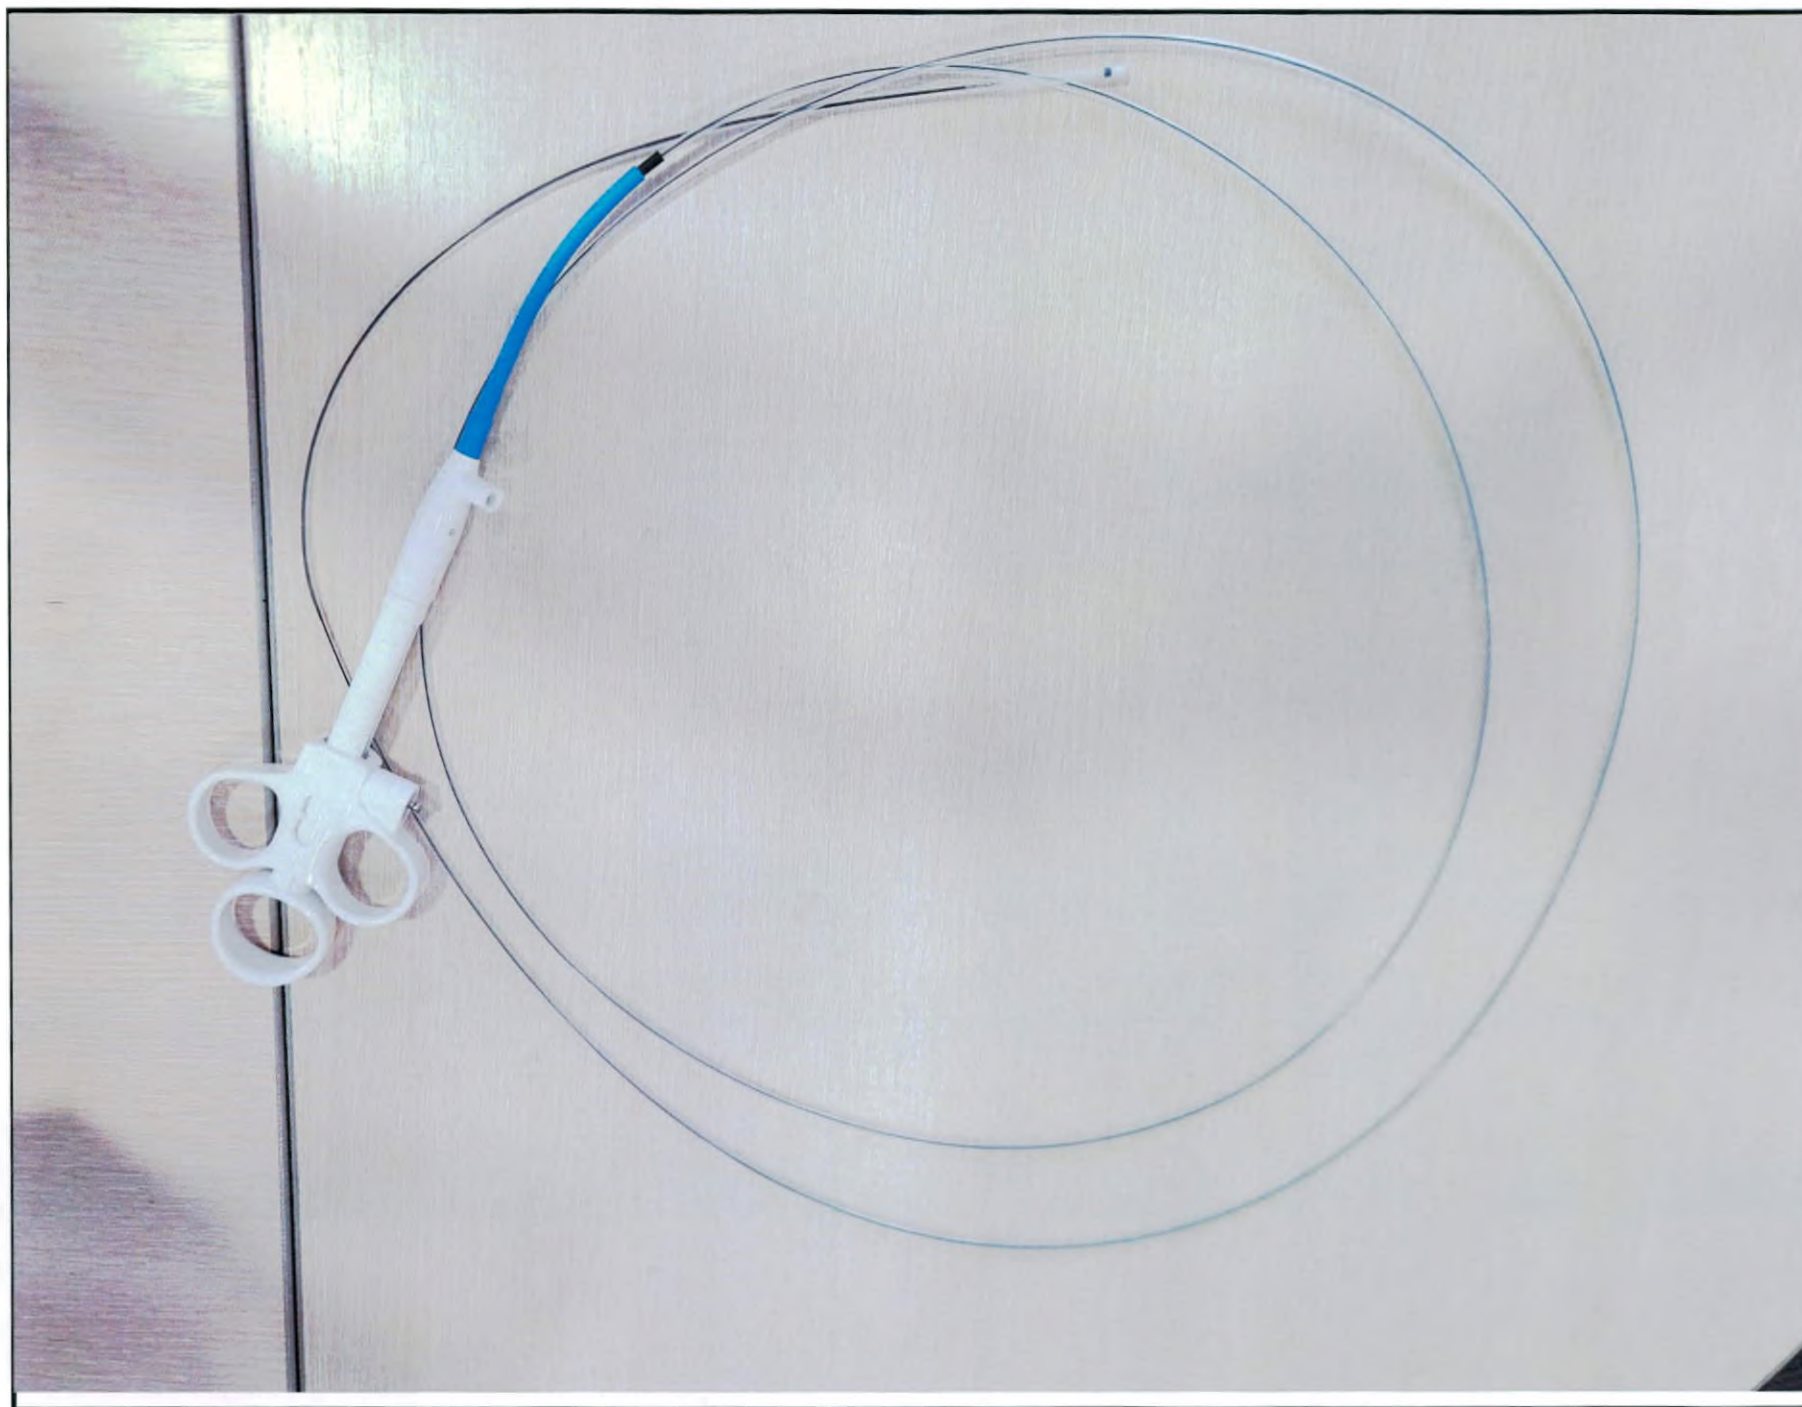

16. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N20- (1 шт./уп.) (Игольчатый тип)

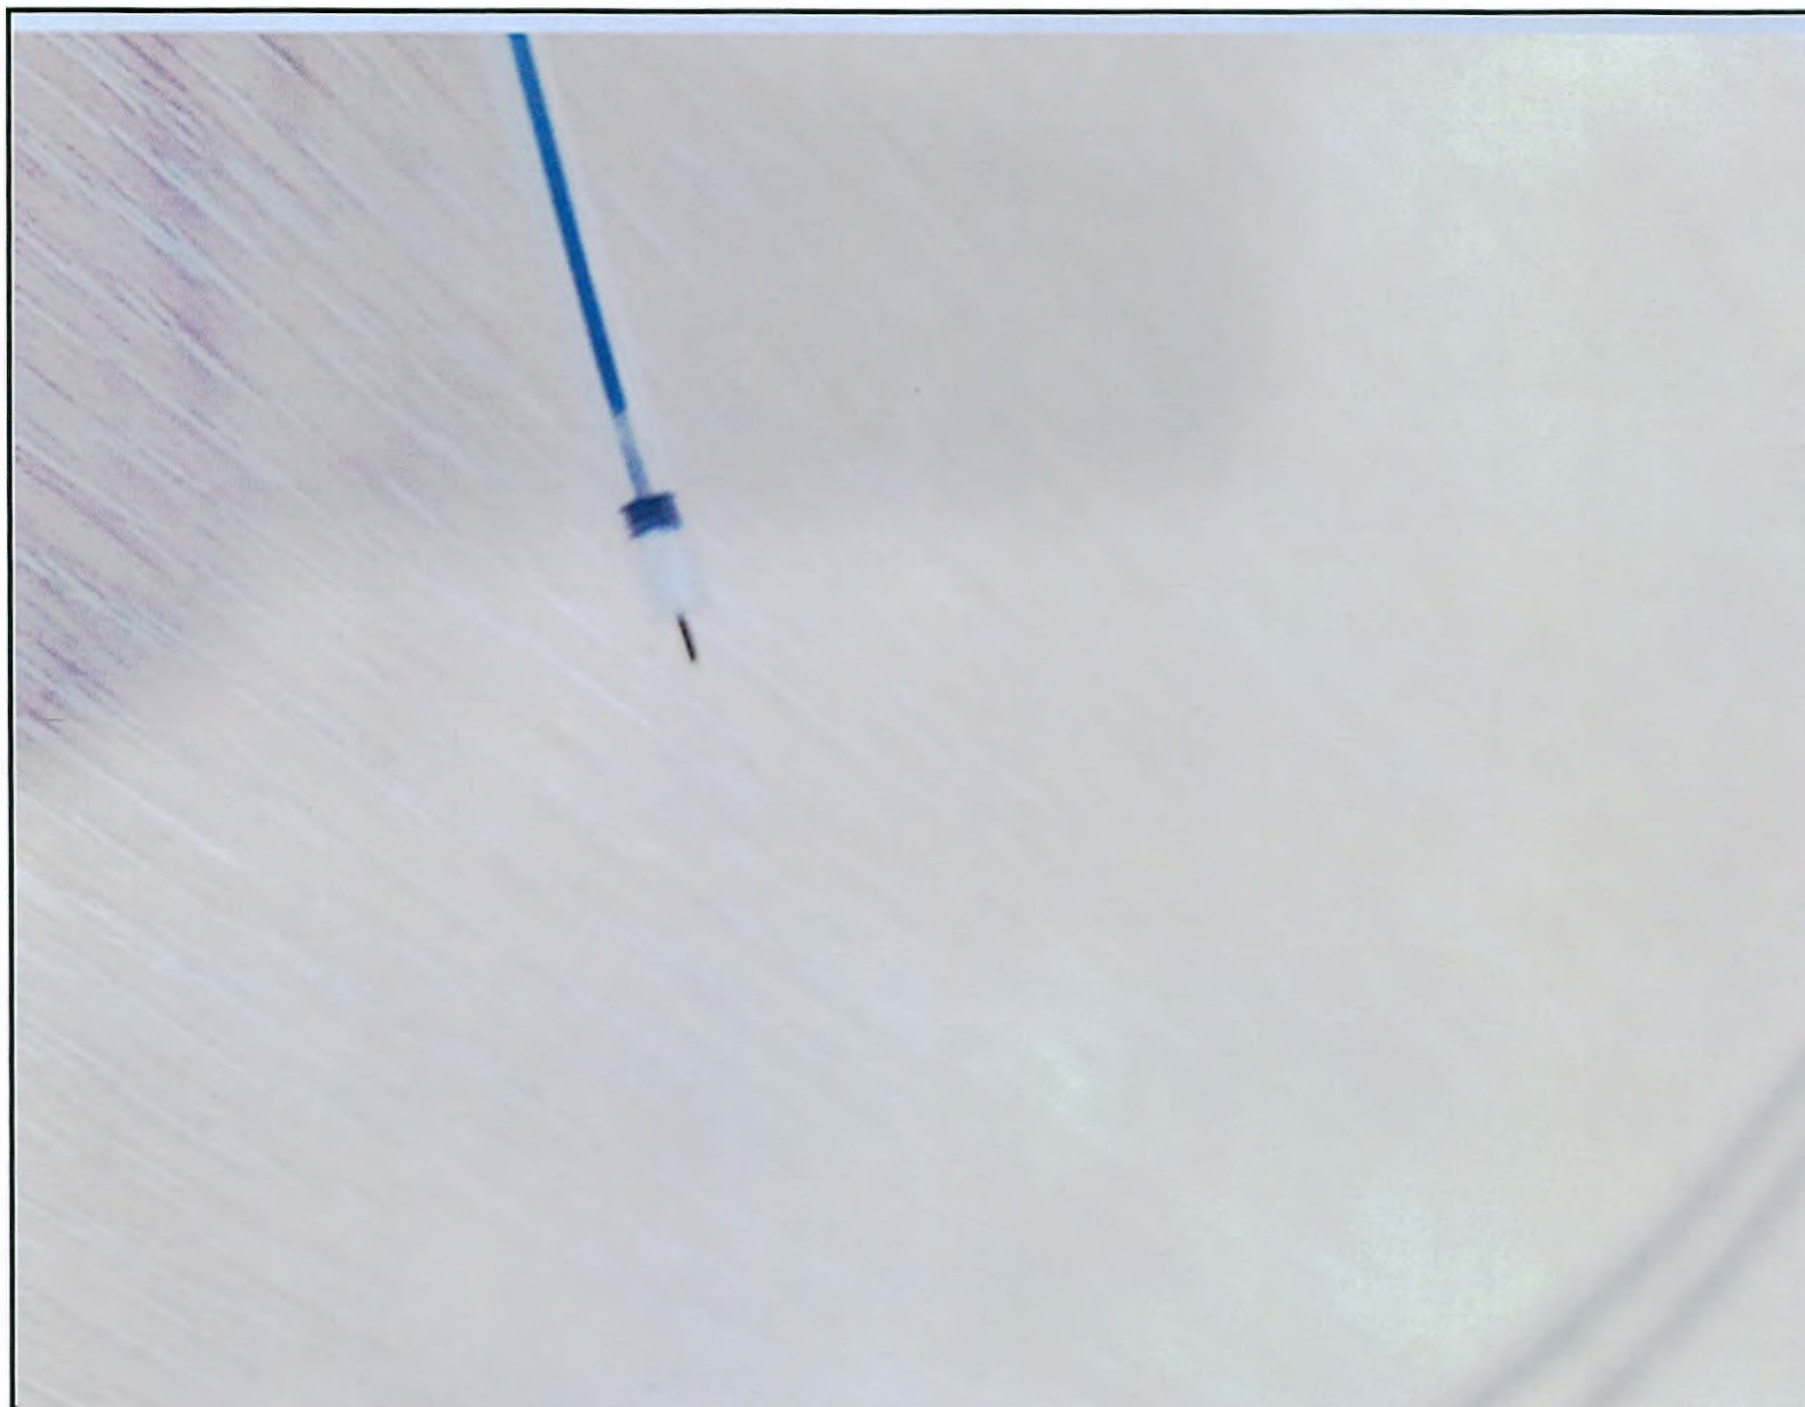

17. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N25- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)


FUJIFILM

FT

FlushKnife **Ns**

DK2620JI -N25-

Diathermic Slitter



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥ 2.8mm



2000mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
de : Arbeitslänge : 2000mm
fr : Longueur utile : 2000mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
es : Longitud de trabajo : 2000mm
pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
nl : Werklengte : 2000mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm



STERILE EO

CE 0123

2018-03

2015-04

LOT 1504A1

MADE IN JAPAN

1504A1

1 pc.

GS1-128



(01)XXXXXXXXXXXX(17)XXXXXX(10)XXXXXX

DK2620JI -N25- FF929A PJ-1

405Y200882B

LN 20180331

17. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N25- (1 шт./уп.)

(общий вид упаковки/картонной коробки)

FUJIFILM
FlushKnife **Ns** **DK2620JI -N25-**
 Diathermic Sitter

2.7mm
2.5mm

≥ 2.8mm 2000mm

en: Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
 de: Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
 fr: Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
 it: Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
 es: Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
 pt: Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
 nl: Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
 tr: Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en: Working Length : 2000mm
 de: Arbeitslänge : 2000mm
 fr: Longueur utile : 2000mm
 it: Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
 es: Longitud de trabajo : 2000mm
 pt: Comprimento de trabalho : 2000mm
 nl: Werk lengte : 2000mm
 tr: Çalışma uzunluğu : 2000mm

1 pc.

GS1-128
 (01)14547410375807(17)240800(10)2109S6
 DK2620JI -N25- FF929A P1-1

STERILE EO
 CE 0123
 2024-08
 2021-09
 LOT 2109S6
 MADE IN JAPAN
 210901

FUJIFILM Corporation
 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku
 Tokyo 106-8620, Japan

FUJIFILM Europe GmbH
 Heesenstrasse 31, 40549 Duesseldorf, Germany

FUJIFILM Europe B.V.
 Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, The Netherlands

Imported to Australia by:
FUJIFILM Australia Pty Ltd
 114 Old Pittwater Road, Brookvale, NSW 2100
 Australia

FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG
 Sumpfstrasse 13, 6312 Sternhausen, Switzerland
 405N204380A

17. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N25- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)

FUJIFILM

FlushKnife Ns

DK2620JI -N25-

Diathermic Slitter

2.7mm
2.5mm

en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici

≥ 2.8mm

2000mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
de : Arbeitslänge : 2000mm
fr : Longueur utile : 2000mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
es : Longitud de trabajo : 2000mm
pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
nl : Werkleugte : 2000mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm

CE 0123

2018-03

2015-04

LOT 1504A1


MADE IN JAPAN
1504A1

GS1-128


(01) XXXXXXXXXXXXX (17) XXXXXX (10) XXXXXX
DK2620JI -N25- FF928A P1-0



17. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N25- (1 шт./уп.)

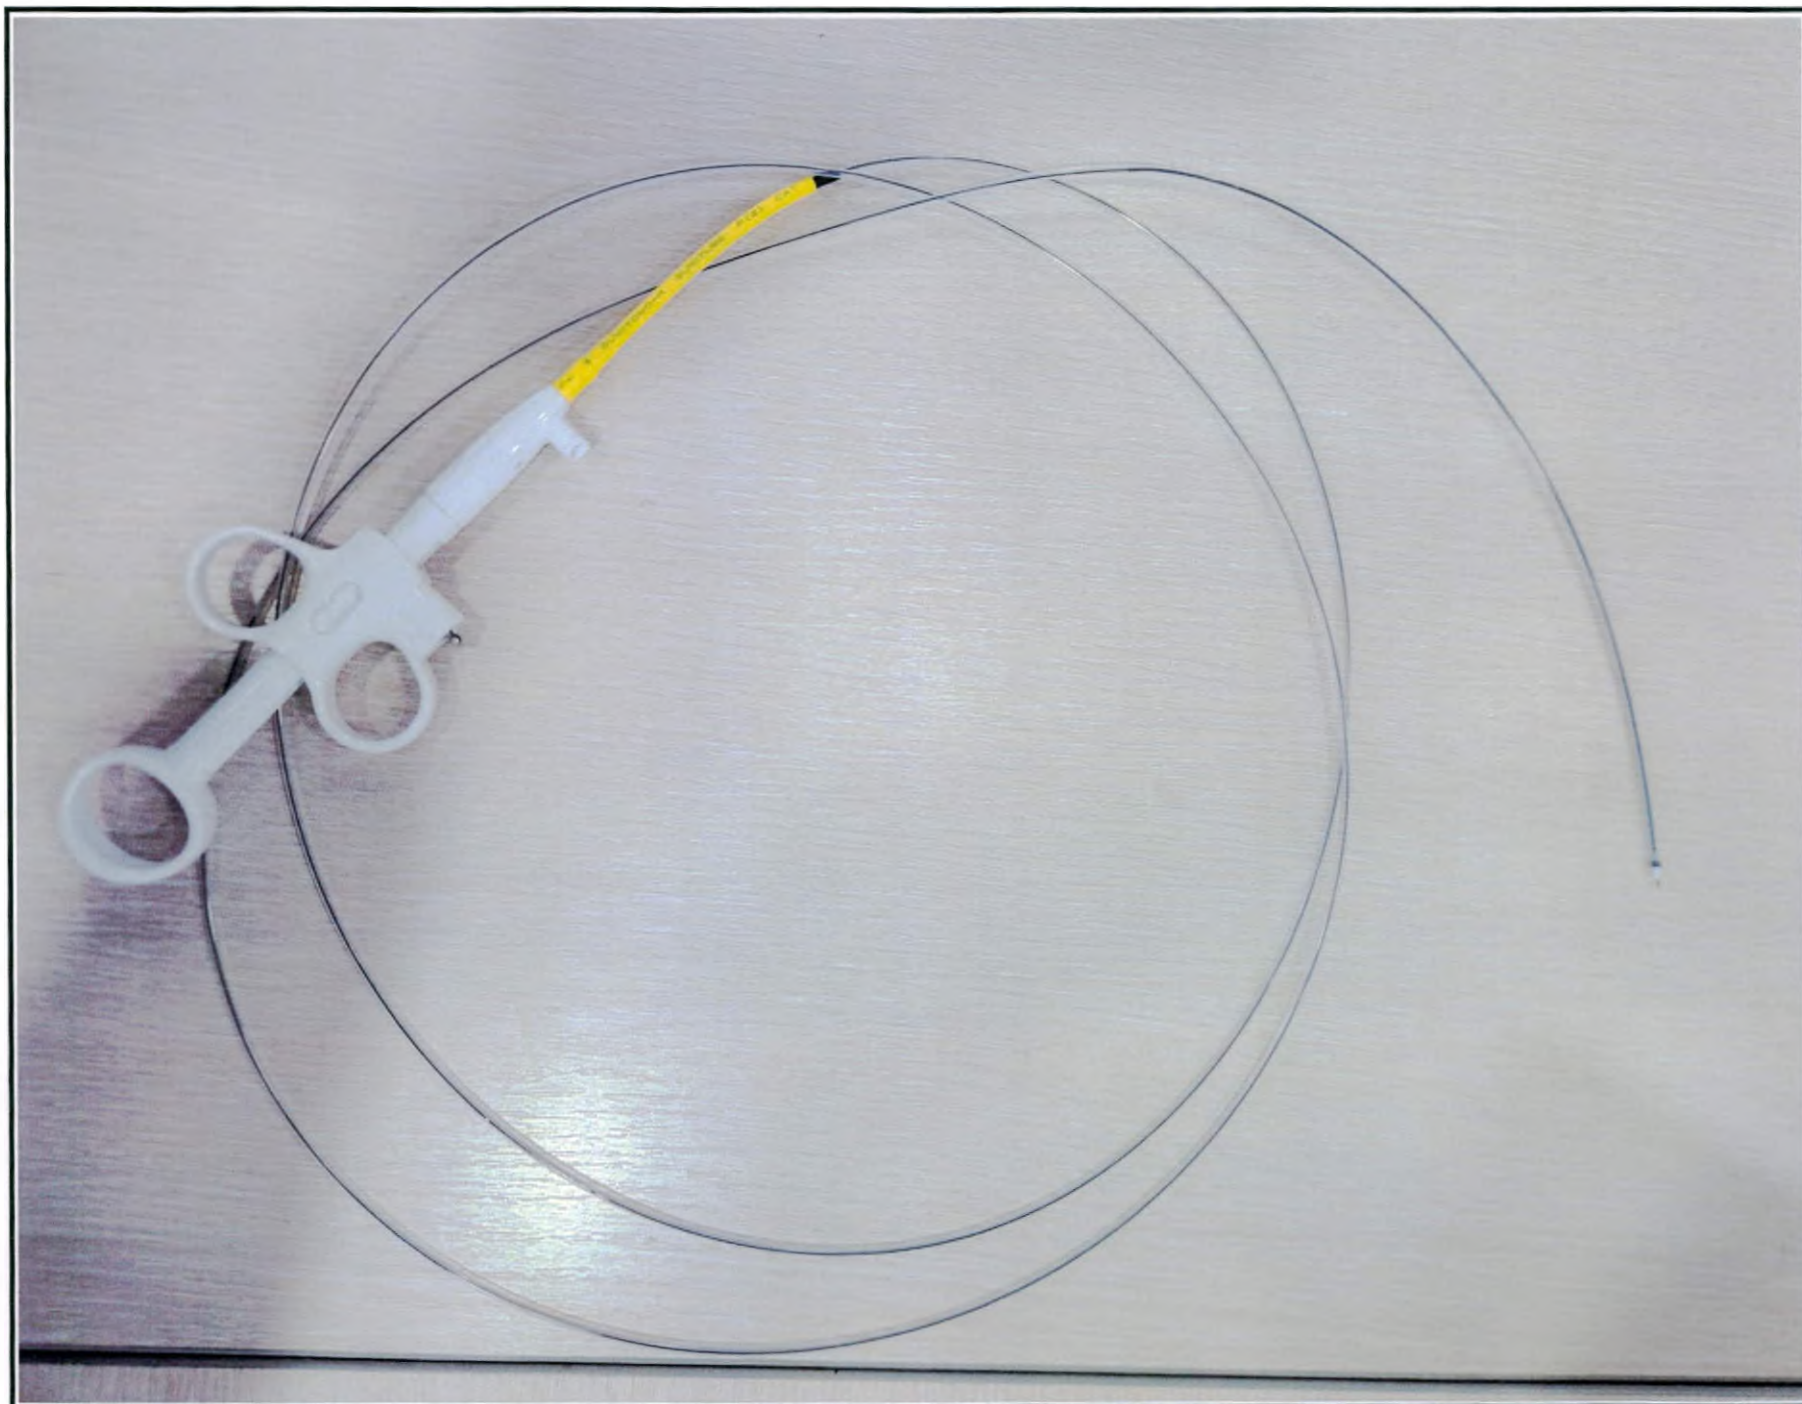

17. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N25- (1 шт./уп.) (Игольчатый тип)

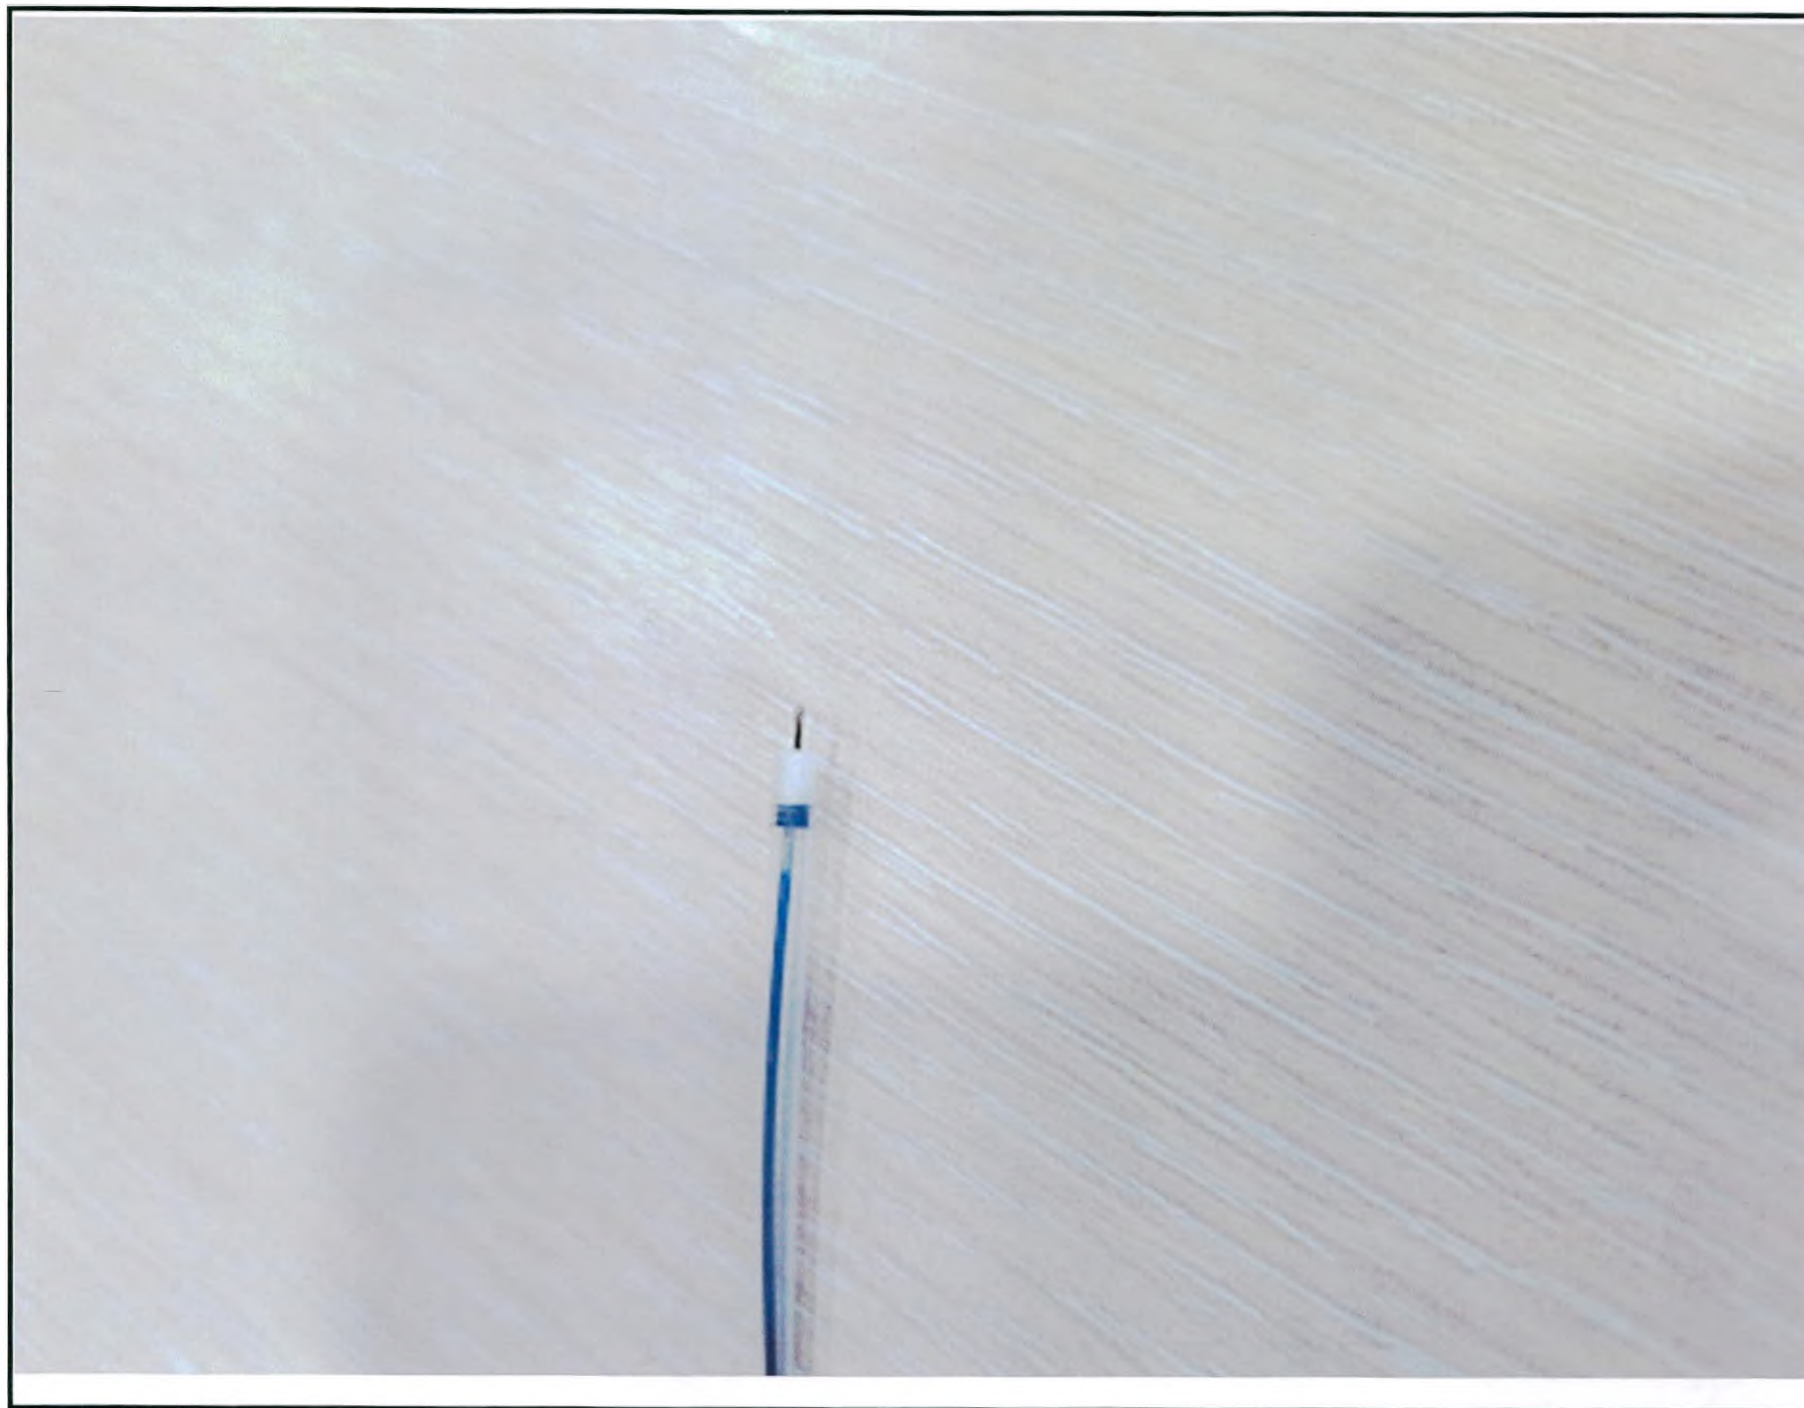

FUJIFILM

FT

FlushKnife **Ns**

DK2620JI -N30-

Diathermic Slitter

en : Diathermic Slitter
 de : Diathermische Sonde
 fr : Couteau diathermique
 it : Bisturi diatermico
 es : Bisturí diatérmico
 pt : Cortador diatérmico
 nl : Diathermische snijmachine
 tr : Diyatermik Dilici

≥ 2.8mm

2000mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
 de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
 fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
 it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
 es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
 pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
 nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
 tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
 de : Arbeitslänge : 2000mm
 fr : Longueur utile : 2000mm
 it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
 es : Longitud de trabajo : 2000mm
 pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
 nl : Werklengte : 2000mm
 tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm

1 pc.

STERILE EO

CE 0123

2018-03

2015-04

LOT 1504A1

MADE IN JAPAN

1504A1

GS1-128

(01) XXXXXXXXXXXXXXX (17) XXXXXXX (10) XXXXXXX

DK2620JI -N30- FF930A PI-1

405Y200883B

LN 20180331

18. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N30- (1 шт./уп.)

(общий вид упаковки/картонной коробки)

FUJIFILM **FlushKnife** **Ns** **DK2620JI -N30-**
Diathermy Sitter

2.7mm **3.0mm**

≥ 2.8mm **2000mm**

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
de : Arbeitslänge : 2000mm
fr : Longueur utile : 2000mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
es : Longitud de trabajo : 2000mm
pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
nl : Werklength : 2000mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm

1 pc.

STERILE EO

CE 0123

2024-08

2021-10

LOT 2109T1

MADE IN JAPAN

2110A1

GS1-128

(01)14547410375814(17)240800(10)2109T1

DK2620JI -N30- FF930A PI-1



FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku
Tokyo 106-8620, Japan



FUJIFILM Europe GmbH
Heesenstrasse 31, 40549 Duesseldorf, Germany

EU Importer :
FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, The Netherlands

Imported to Australia by :
FUJIFILM Australia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road, Brookvale, NSW, 2100
Australia



FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG
Sumplstrasse 13, 6312 Steinhausen, Switzerland

405N204380A


18. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N30- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)

FUJIFILM

FlushKnife Ns

DK2620JI -N30-

Diathermic Slitter



2.7mm
3.0mm



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥2.8mm



2000mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2000mm
de : Arbeitslänge : 2000mm
fr : Longueur utile : 2000mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2000mm
es : Longitud de trabajo : 2000mm
pt : Comprimento de trabalho : 2000mm
nl : Werklengte : 2000mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2000mm








STERILE EO



CE 0123

2018-03

2015-04

LOT 1504A1

MADE IN JAPAN
1504A1


GS1-128



(01) XXXXXXXXXXXXX (17) XXXXXX (10) XXXXXX
DK2620JI -N30- FF930A PI-0



18. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N30- (1 шт./уп.)

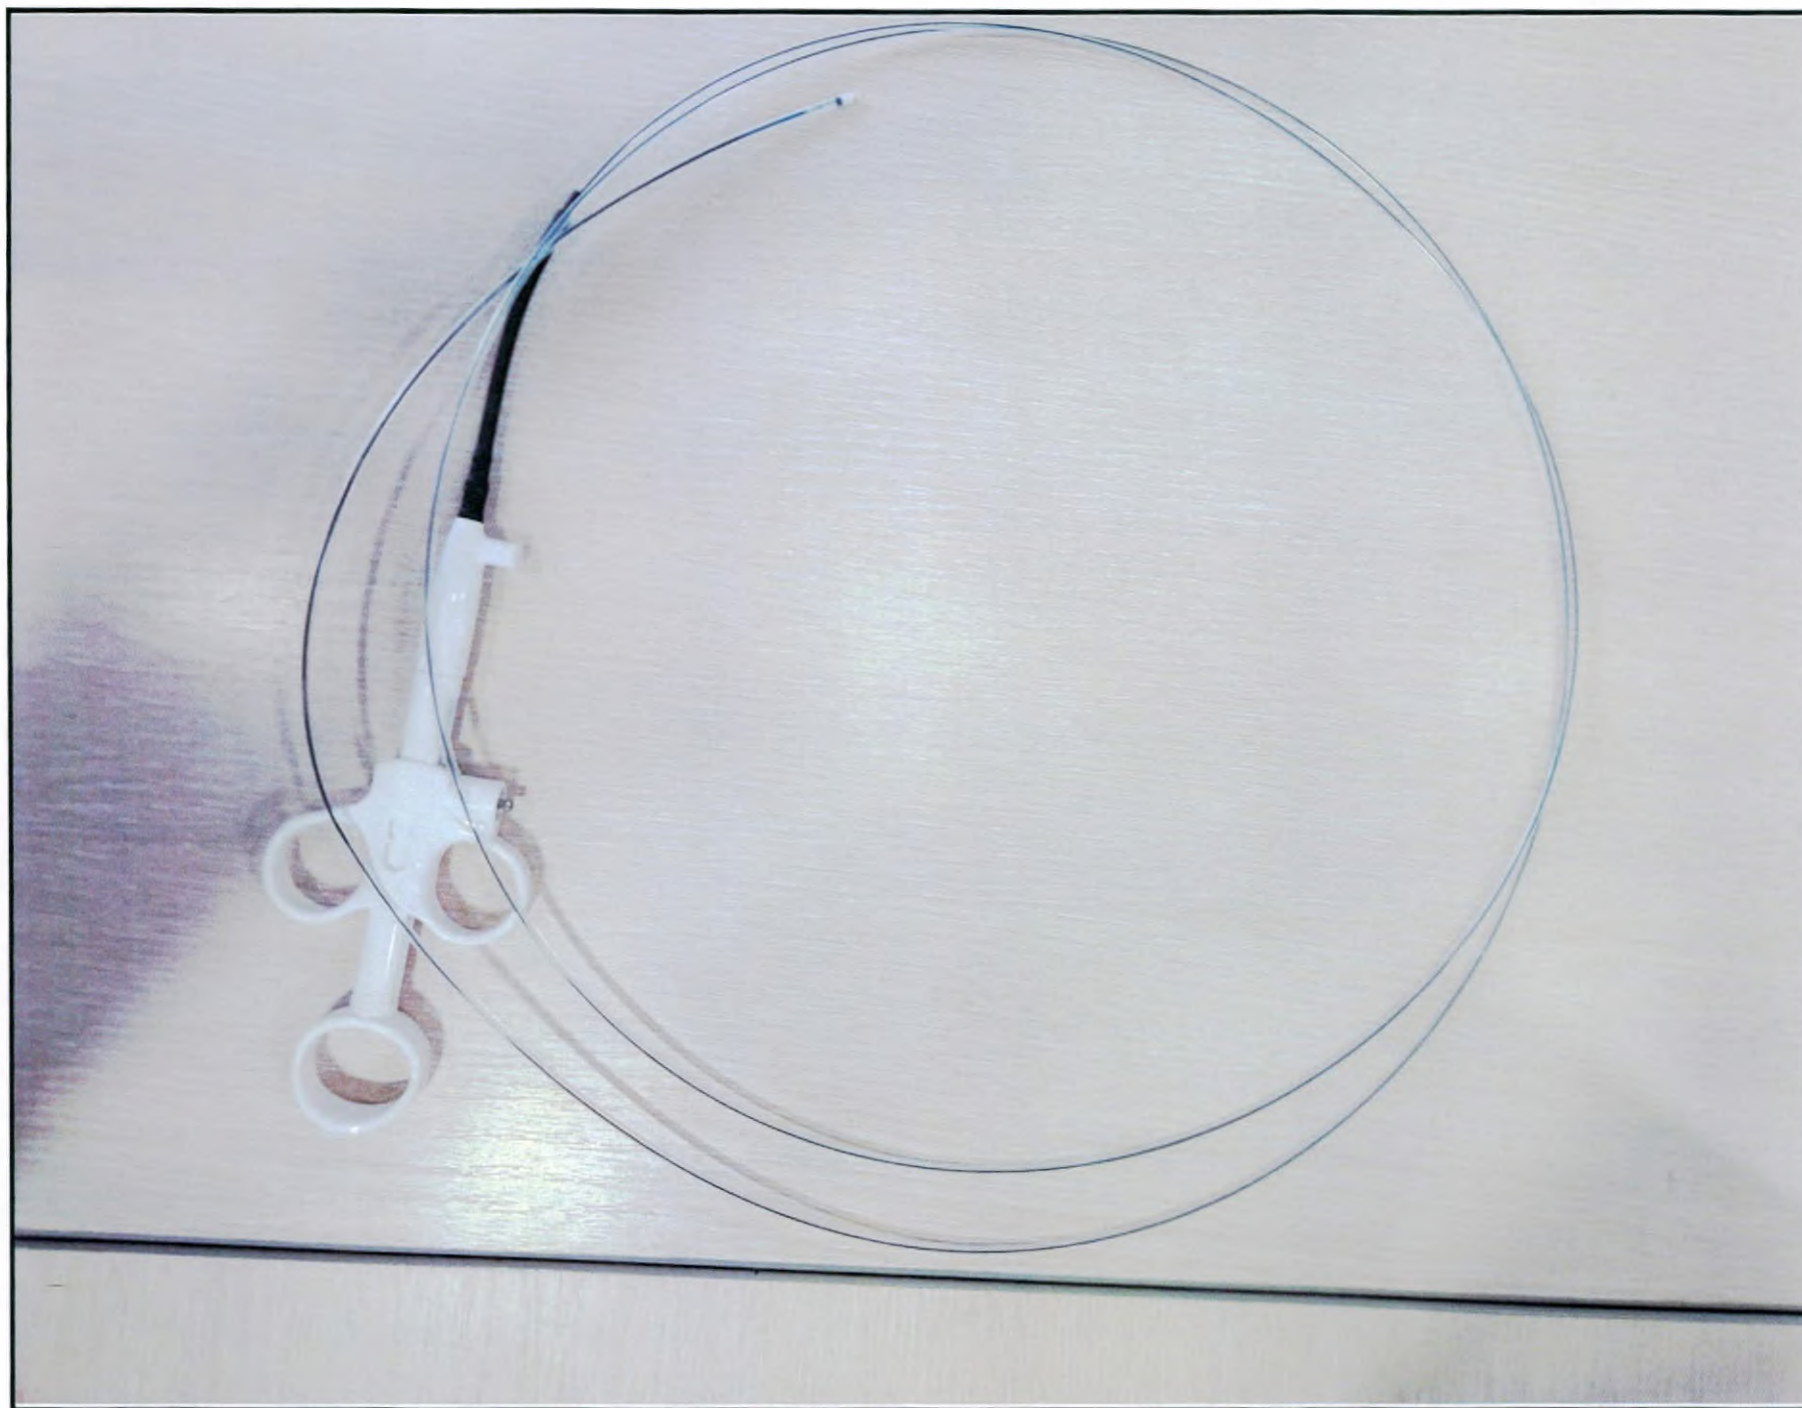

18. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2620JI-N30- (1 шт./уп.) (Игольчатый тип)




19. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2623JI-N15- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)

FUJIFILM

FT

FlushKnife **Ns****DK2623JI -N15-**

Diathermic Slitter



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici

**≥ 2.8mm****2300mm**

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2300mm
de : Arbeitslänge : 2300mm
fr : Longueur utile : 2300mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2300mm
es : Longitud de trabajo : 2300mm
pt : Comprimento de trabalho : 2300mm
nl : Werklengete : 2300mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2300mm



STERILE EO



CE 0123

2018-03

2015-04

LOT 1504A1

MADE IN JAPAN
1504A1**1 pc.**

GS1-128



(01) XXXXXXXXXXXXXXX (17) XXXXXX (10) XXXXXX

DK2623JI -N15- FF943A PI-1

405Y200888B

LN 20180331

FUJIFILM

FlushKnife^{NS} **DK2623JI -N15-**
Diathermic Knife

2.7mm
1.5mm

≥2.8mm **2300mm**

en : Diathermic Blade
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturi diatermico
pt : Cortador diatermico
nl : Diathermische snijmachina
tr : Diatermik Dilci

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2300mm
de : Arbeitslänge : 2300mm
fr : Longueur utile : 2300mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2300mm
es : Longitud de trabajo : 2300mm
pt : Comprimento de trabalho : 2300mm
nl : Werk lengte : 2300mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2300mm

1 pc.

STERILE EO

CE 0123

2024-10

2021-12

LOT 2111T5

MADE IN JAPAN

2112A3

GS1-128

(01)14547410375869(17)241000(10)2111T5

DK2623JI -N15- FF943A P1-1



FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku
Tokyo 106-8620, Japan



FUJIFILM Europe GmbH
Heesenstrasse 31, 40549 Duesseldorf, Germany

EU Importer :
FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, The Netherlands

Imported to Australia by :
FUJIFILM Australia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road, Brookvale, NSW, 2100
Australia



FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG
Sumpfstrasse 13, 6312 Steinhausen, Switzerland


405N204380A

19. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2623JI-N15- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)

FUJIFILM (FT)

FlushKnife Ns **DK2623JI -N15-**

Diathermic Slitter




2.7mm
1.5mm



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥ 2.8mm



2300mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführtells : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2300mm
de : Arbeitslänge : 2300mm
fr : Longueur utile : 2300mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2300mm
es : Longitud de trabajo : 2300mm
pt : Comprimento de trabalho : 2300mm
nl : Werkleugte : 2300mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2300mm











GS1-128



(01) XXXXXXXXXXXXX (17) XXXXXX (10) XXXXXX
DK2623JI -N15- FF943A PI-0

STERILE EO

CE 0123

2018-03


2015-04

LOT 1504A1


MADE IN JAPAN
1504A1



19. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2623JI-N15- (1 шт./уп.)

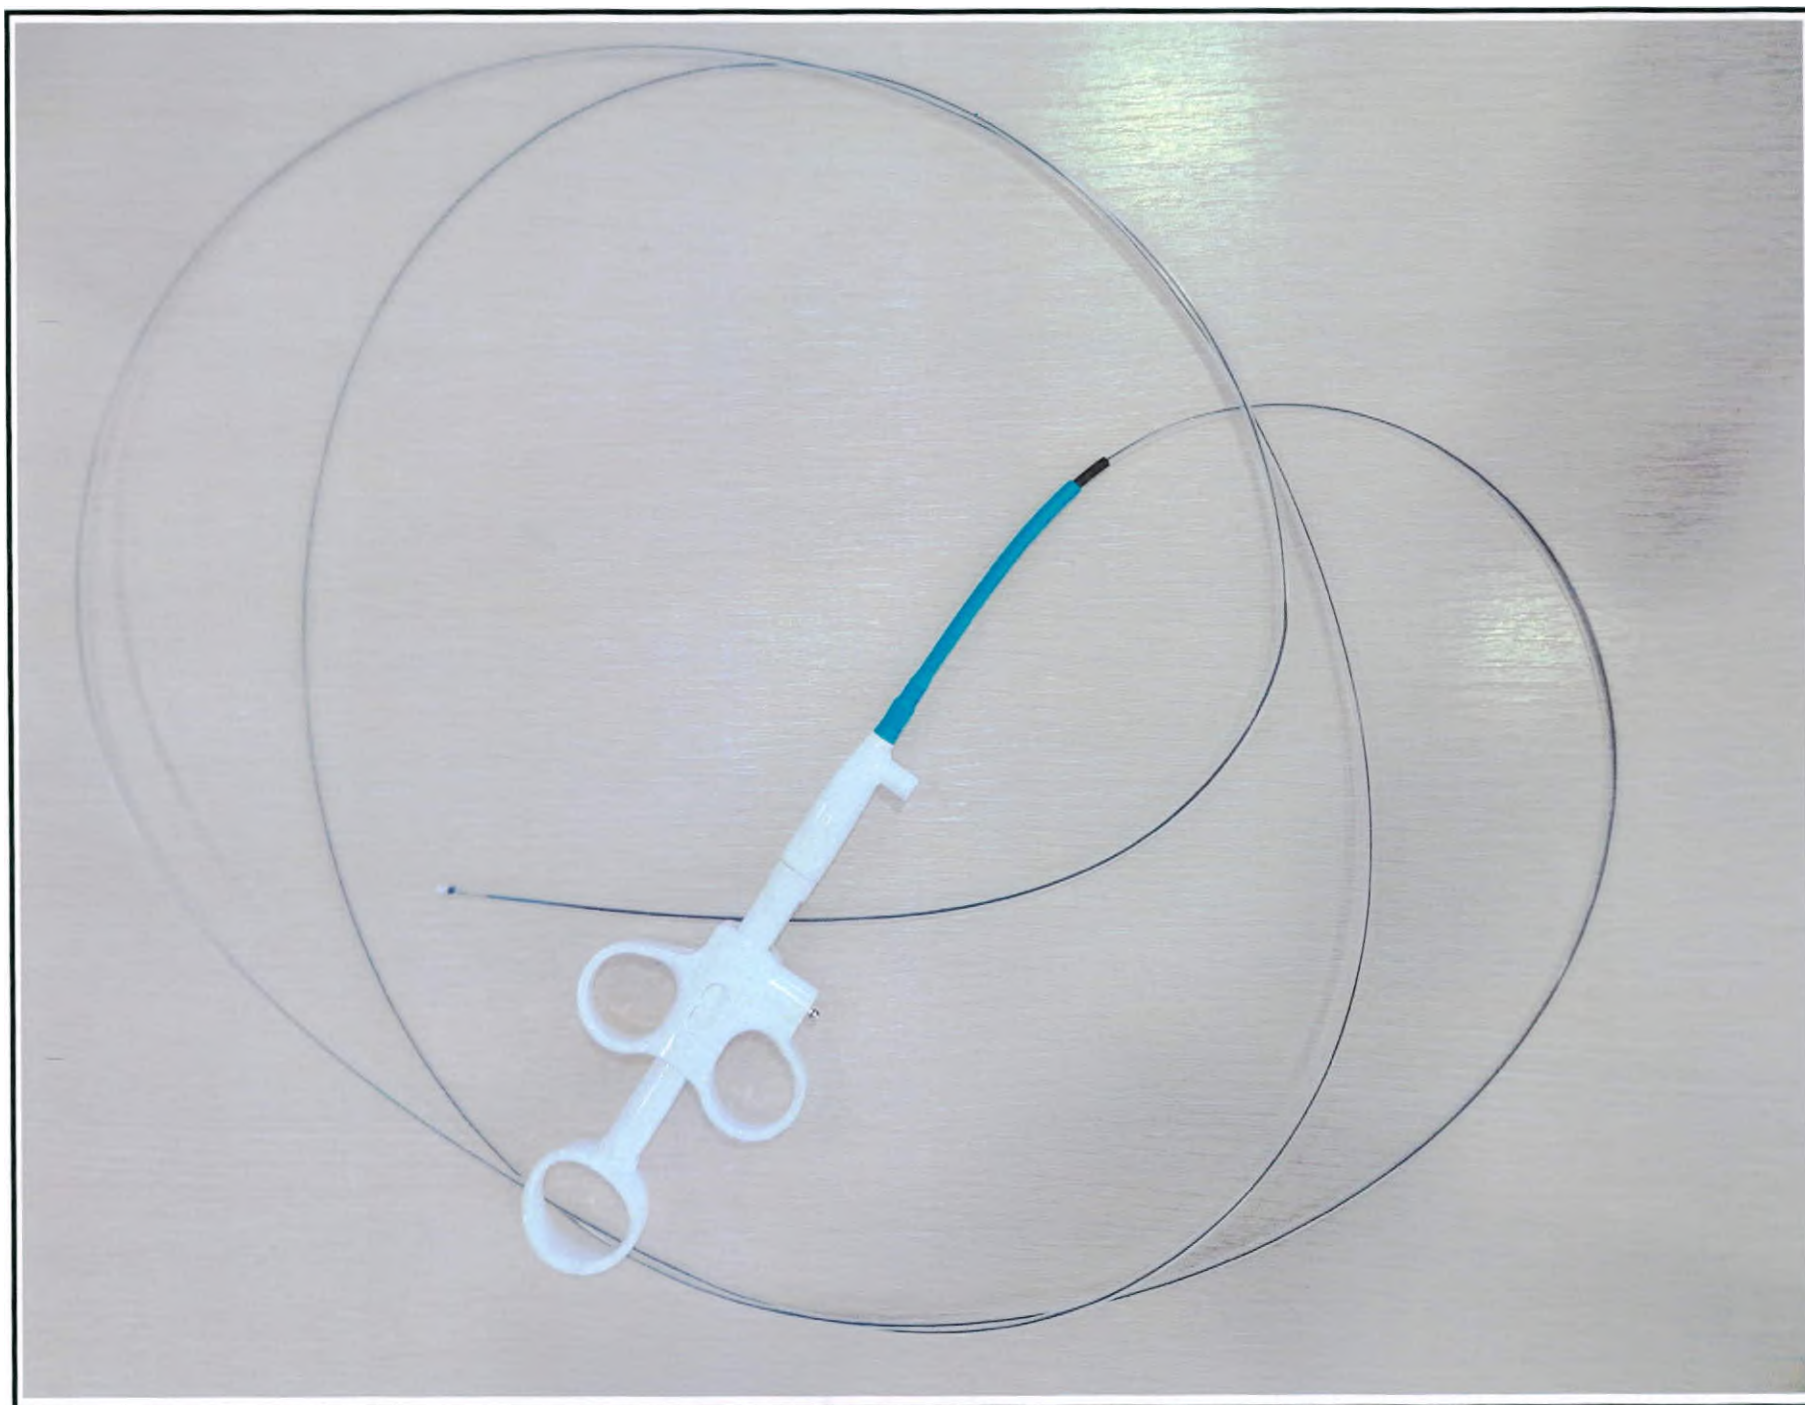

19. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2623JI-N15- (1 шт./уп.) (Игольчатый тип)

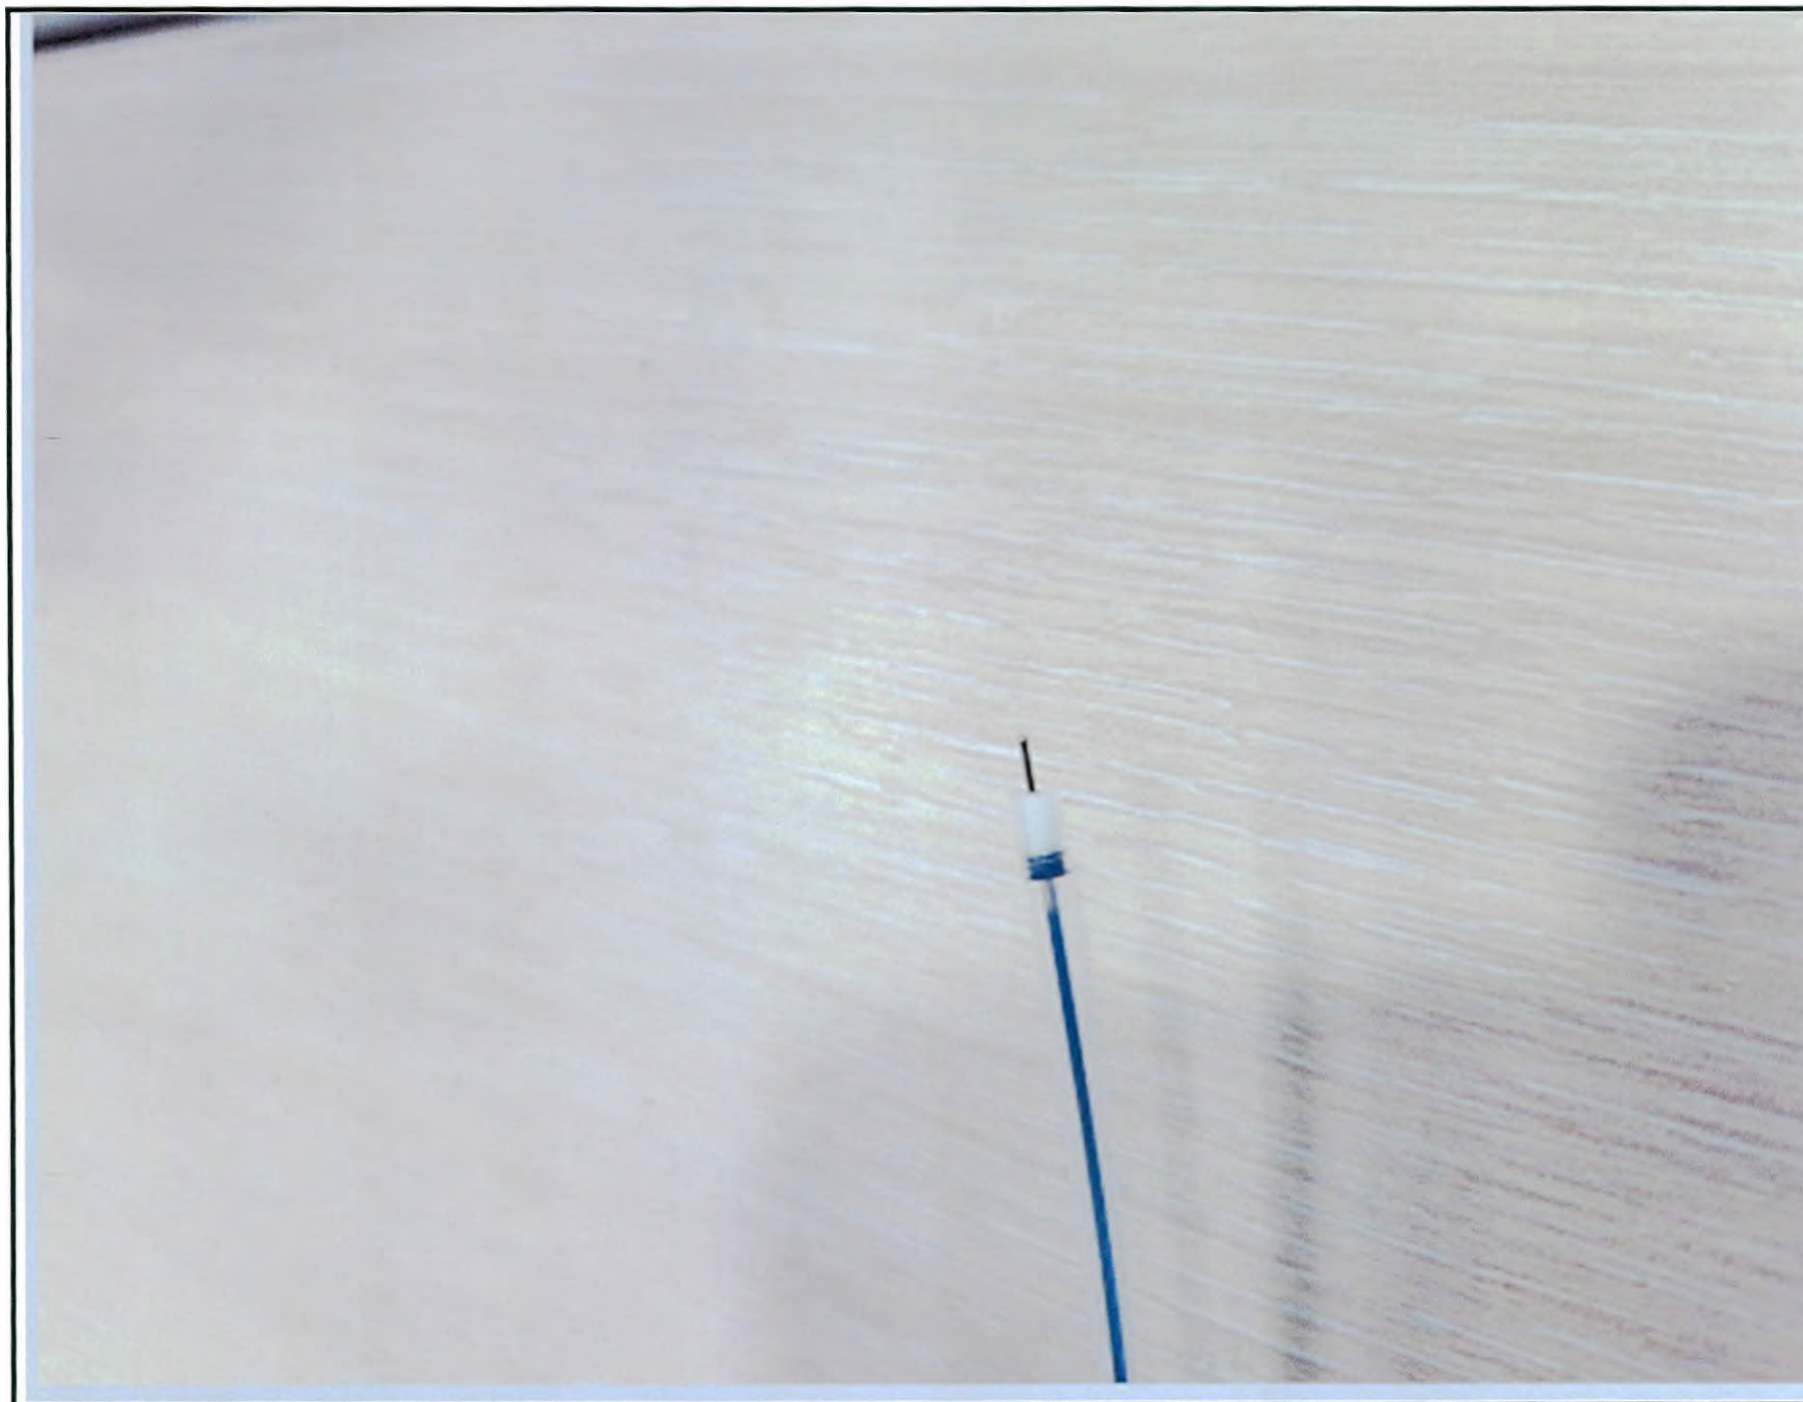


20. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2623JI-N20- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)

FUJIFILM

FT

FlushKnife **Ns** DK2623JI -N20-

Diathermic Slitter



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥ 2.8mm



2300mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2300mm
de : Arbeitslänge : 2300mm
fr : Longueur utile : 2300mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2300mm
es : Longitud de trabajo : 2300mm
pt : Comprimento de trabalho : 2300mm
nl : Werklengte : 2300mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2300mm



STERILE EO



CE 0123



2018-03



2015-04



LOT 1504A1

MADE IN JAPAN

1504A1

GS1-128



(01) XXXXXXXXXXXX (17) XXXXXX (10) XXXXXX

DK2623JI -N20- FF944A PI-1

405Y200889B

LN 20180331

FUJIFILM
FlushKnife^{NS} **DK2623JI -N20-**
Diathermic Sitter

en: Diathermic Sitter
de: Diathermische Sonde
fr: Coûtéau diathermique
it: Bisturi diatermico
es: Bisturi diatermico
pt: Cortador diatermico
nl: Diathermische snijmachine
tr: Dinamik Döke

2.7mm
2.0mm

$\geq 2.8mm$ 2300mm

en: Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de: Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr: Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it: Diametro massimo della sezione di inserzione : 2.7mm
es: Diametro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt: Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl: Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr: Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en: Working Length : 2300mm
de: Arbeitslänge : 2300mm
fr: Longueur utile : 2300mm
it: Lunghezza utile di lavoro : 2300mm
es: Longitud de trabajo : 2300mm
pt: Comprimento de trabalho : 2300mm
nl: Werk lengte : 2300mm
tr: Çalışma uzunluğu : 2300mm

1 pc.

GS1-128
00114547410375876(17)240700(10)2108T5
DK2623JI -N20- FF944A PI-1

STERILE EO

CE 0123

2024-07

2021-09

LOT 2108T5

MADE IN JAPAN

2109B5

FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku
Tokyo 106-8520, Japan

FUJIFILM Europe GmbH
Heesenstrasse 31, 40549 Düsseldorf, Germany

EU Importer :
FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, The Netherlands

Imported to Australia by :
FUJIFILM Australia Pty Ltd
114 Old Pittwater Road, Brookvale, NSW, 2100
Australia


FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG
Sumpfstrasse 13, 6312 Steinhausen, Switzerland
400N204380A

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


20. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2623JI-N20- (1 шт./уп.) - стерильная упаковка



20. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2623Л-N20- (1 шт./уп.)

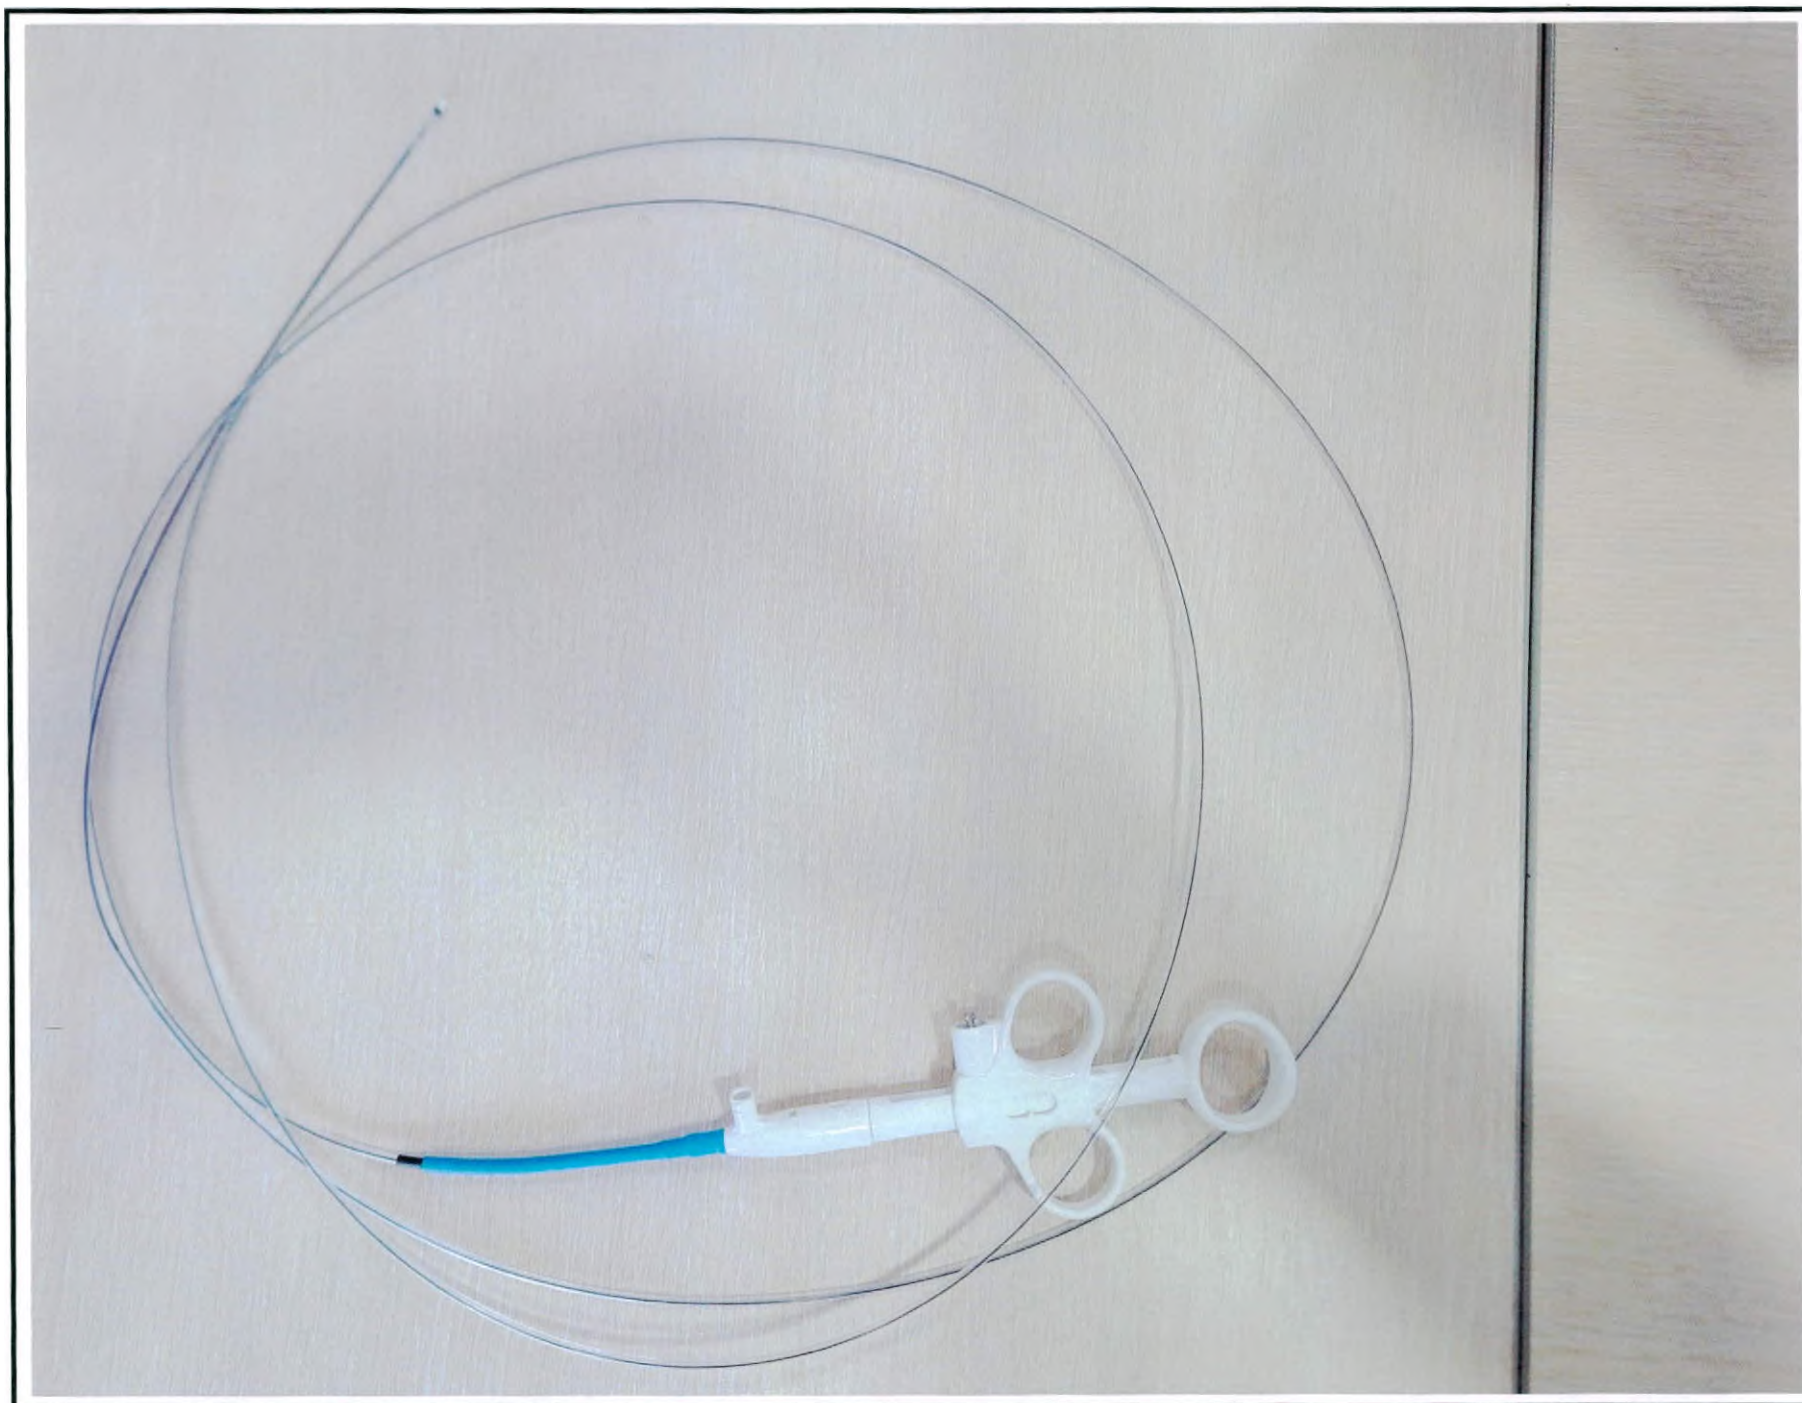

20. Нож для абляции, надреза, иссечения и авульсии ткани DK2623JI-N20- (1 шт./уп.) (Игольчатый тип)

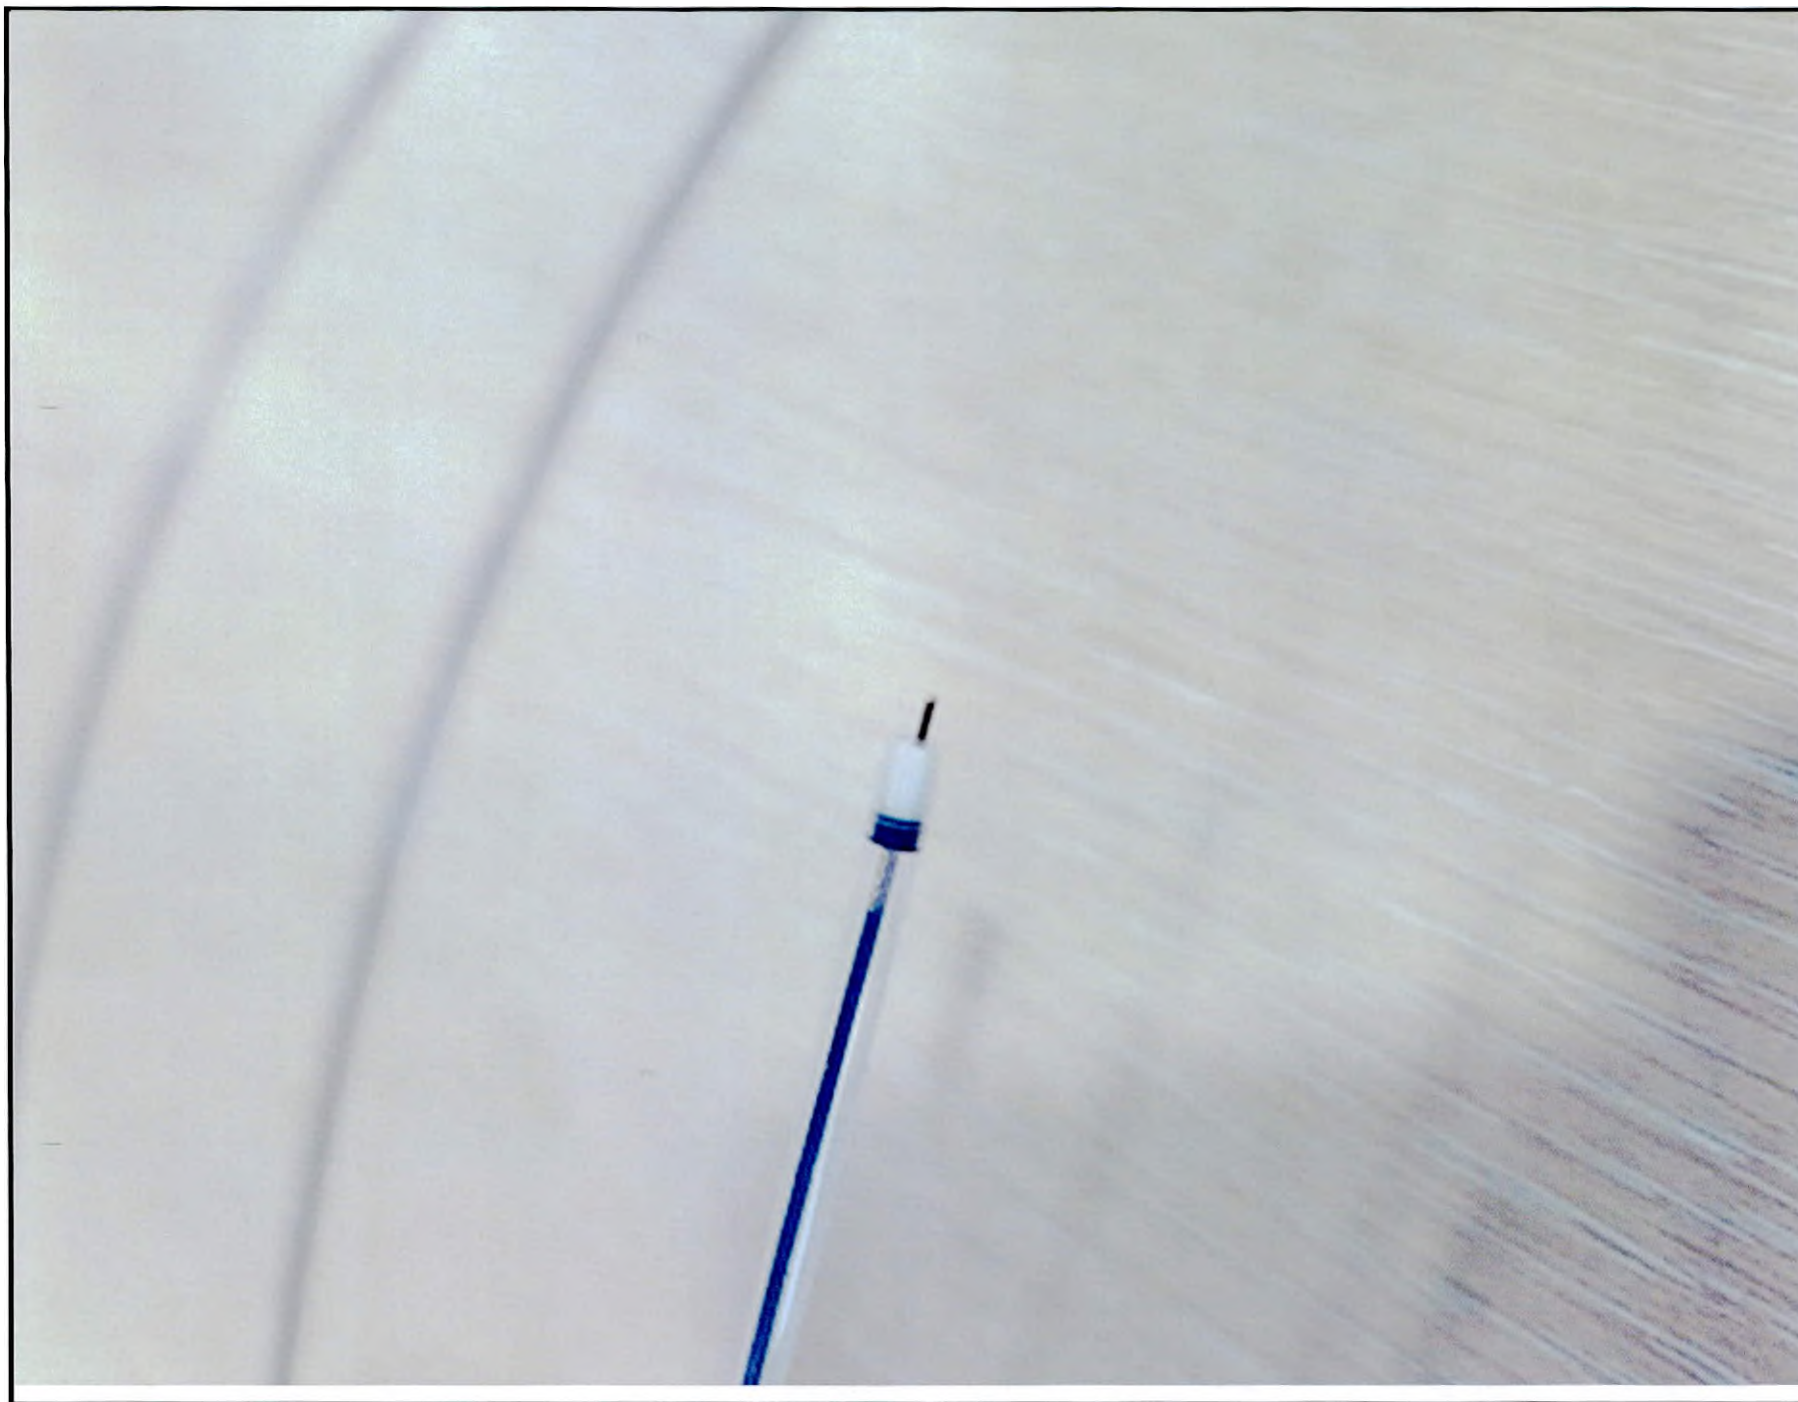


21. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623JI-B15- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)






DK2623JI -B15-

Diathermic Slitter





en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilci



≥ 2.8mm



2300mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2300mm
de : Arbeitslänge : 2300mm
fr : Longueur utile : 2300mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2300mm
es : Longitud de trabajo : 2300mm
pt : Comprimento de trabalho : 2300mm
nl : Werklengte : 2300mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2300mm






1 pc.



STERILE EO



CE 0123

 2018-03

 2015-04

LOT 1504A1

MADE IN JAPAN

GS1-128



(01)XXXXXXXXXXXX(17)XXXXXX(10)XXXXXX

DK2623JI -B15- FF945A PI-1

405Y200890B LN 20180331 1504A1

21. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, остановки кровотечения DK2623JI-B15- (1 шт./уп.) (общий вид упаковки/картонной коробки)

FUJIFILM
FlushKnife **B15** **DK2623JI -B15-**
 Diathermic Shear

2.7mm
1.5mm

≥ 2.8mm
2300mm

en: Maximum diameter of insertion portion: 2.7mm
 de: Maximaler Durchmesser des Einführteils: 2.7mm
 fr: Diamètre maximum de la partie à insérer: 2.7mm
 it: Diametro massimo della sezione di inserimento: 2.7mm
 es: Diámetro máximo de la parte de inserción: 2.7mm
 pt: Diámetro máximo da parte de inserção: 2.7mm
 nl: Maximale diameter van inbrengdeel: 2.7mm
 tr: Takma kısmının maksimum çapı: 2.7mm

en: Working Length: 2300mm
 de: Arbeitslänge: 2300mm
 fr: Longueur utile: 2300mm
 it: Lunghezza utile di lavoro: 2300mm
 es: Longitud de trabajo: 2300mm
 pt: Comprimento de trabalho: 2300mm
 nl: Werk lengte: 2300mm
 tr: Çalışma uzunluğu: 2300mm

1 pc.

STERILE EO

CE 0123

2024-08

2021-10

LOT 2109T7

MADE IN JAPAN
 2110R5

GS1-128
 (01)14547410375883(17)240800(10)2109T7
 DK2623JI-B15-FF945A P1-1

FUJIFILM Corporation
 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku
 Tokyo 106-8620, Japan

FUJIFILM Europe GmbH
 Heesenstrasse 31, 40549 Duesseldorf, Germany

EU Importer:
FUJIFILM Europe B.V.
 Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, The Netherlands

Imported to Australia by:
FUJIFILM Australia Pty Ltd
 114 Old Pittwater Road, Brookvale, NSW, 2100
 Australia

FUJIFILM Healthcare Europe Holding AG
 Sumpfstrasse 13, 6312 Steinhausen, Switzerland

40SN204380A

21. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623JI-B15- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)


FUJIFILM

FT

FlushKnife **BTs**

DK2623JI -B15-

Diathermic Slitter



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturi diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥2.8mm



2300mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van Inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2300mm
de : Arbeitslänge : 2300mm
fr : Longueur utile : 2300mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2300mm
es : Longitud de trabajo : 2300mm
pt : Comprimento de trabalho : 2300mm
nl : Werklength : 2300mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2300mm



STERILE EO



CE 0123



2018-03



2015-04

LOT

1504A1

MADE IN JAPAN

1504A1

GS1-128




(01) XXXXXXXXXXXXX (17) XXXXXX (10) XXXXXX

DK2623JI -B15- FF945A PI-0


21. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623JI-B15- (1 шт./уп.) - стерильная упаковка



21. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623JI

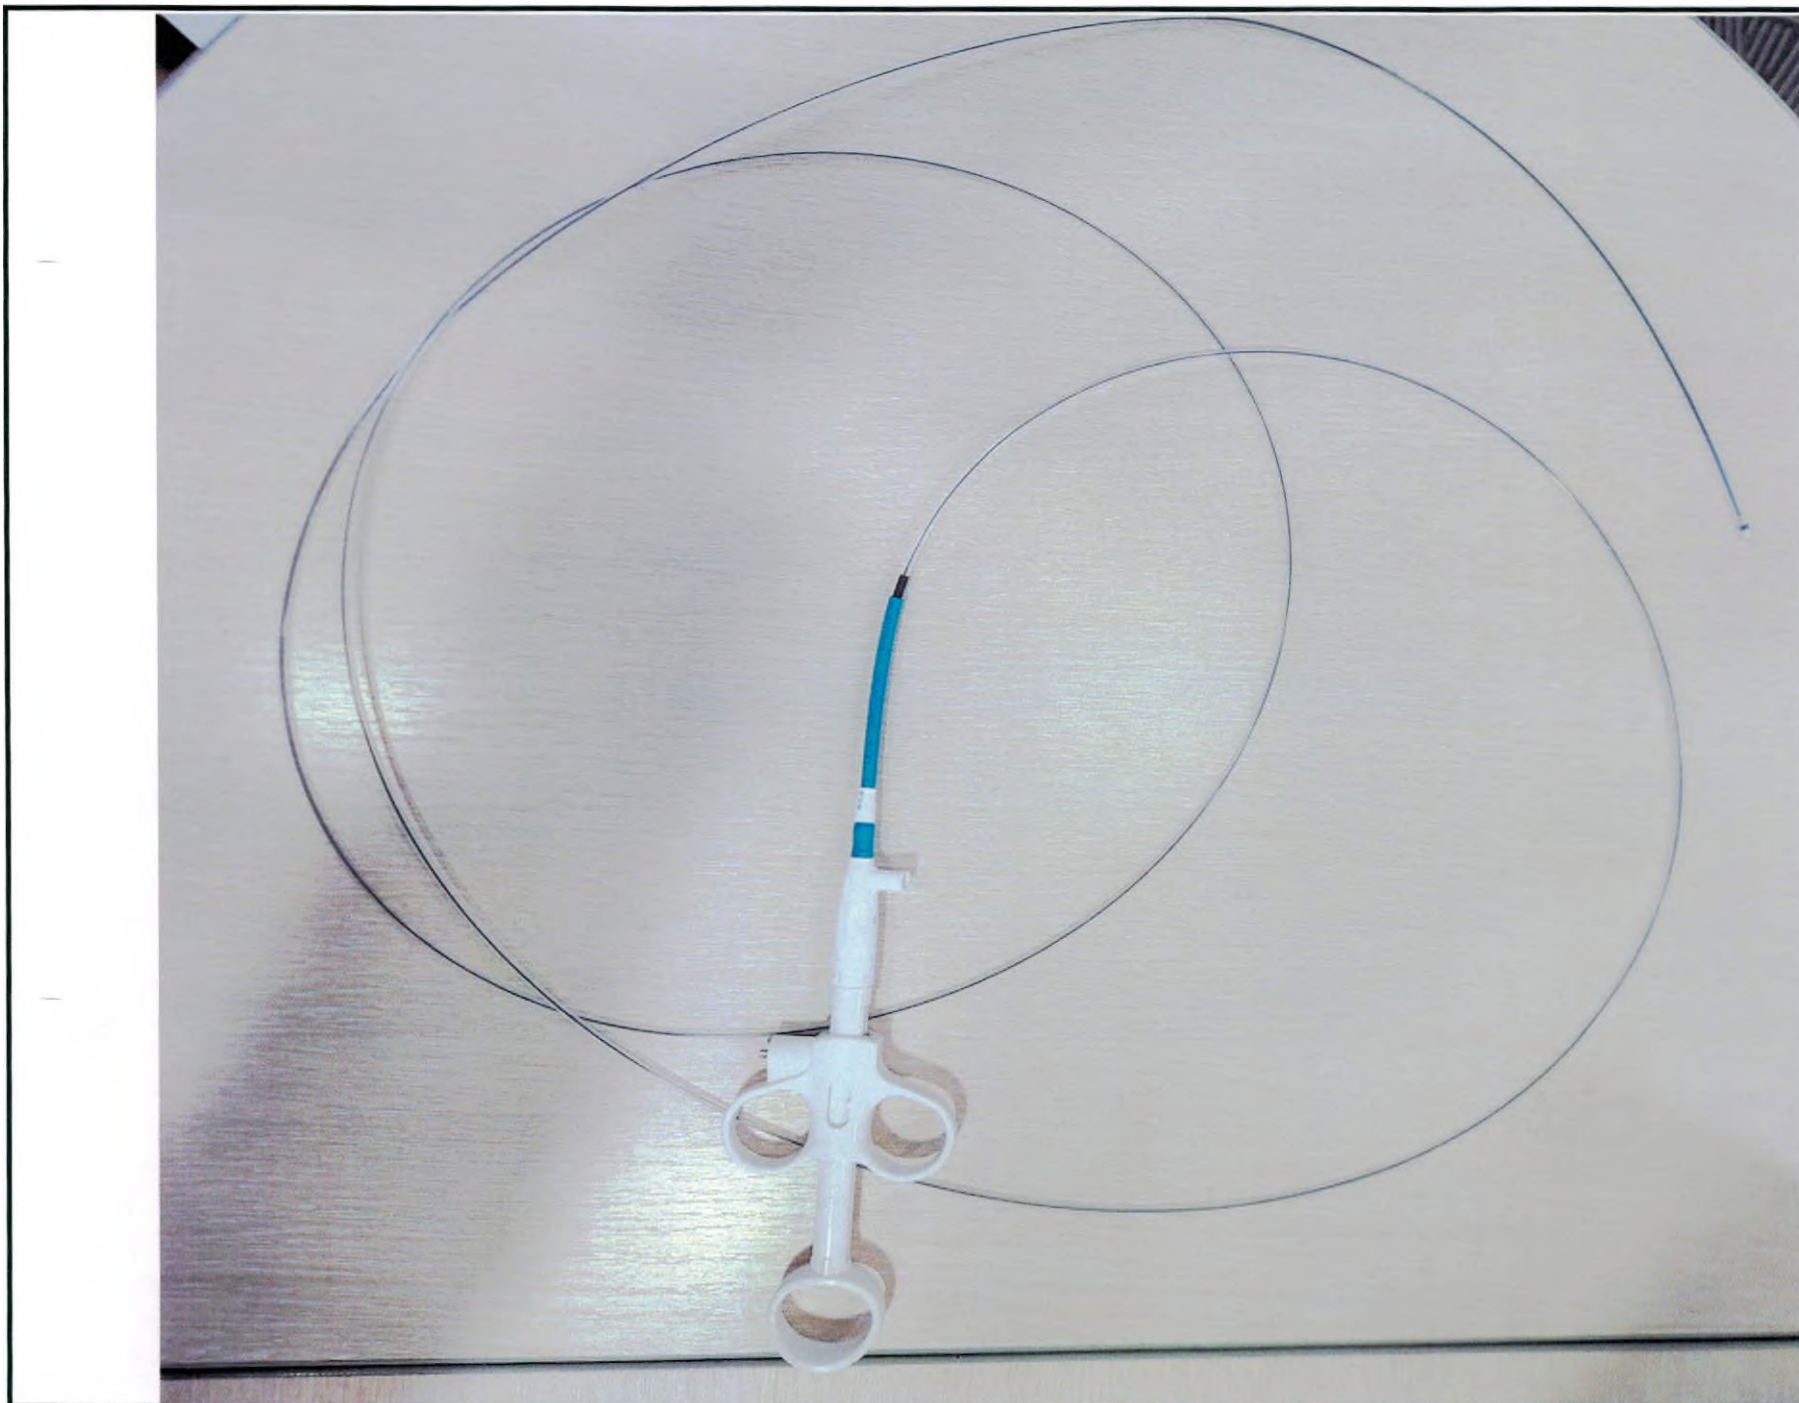

21. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623JI-B15- (1 шт./уп.) (Круглый тип)

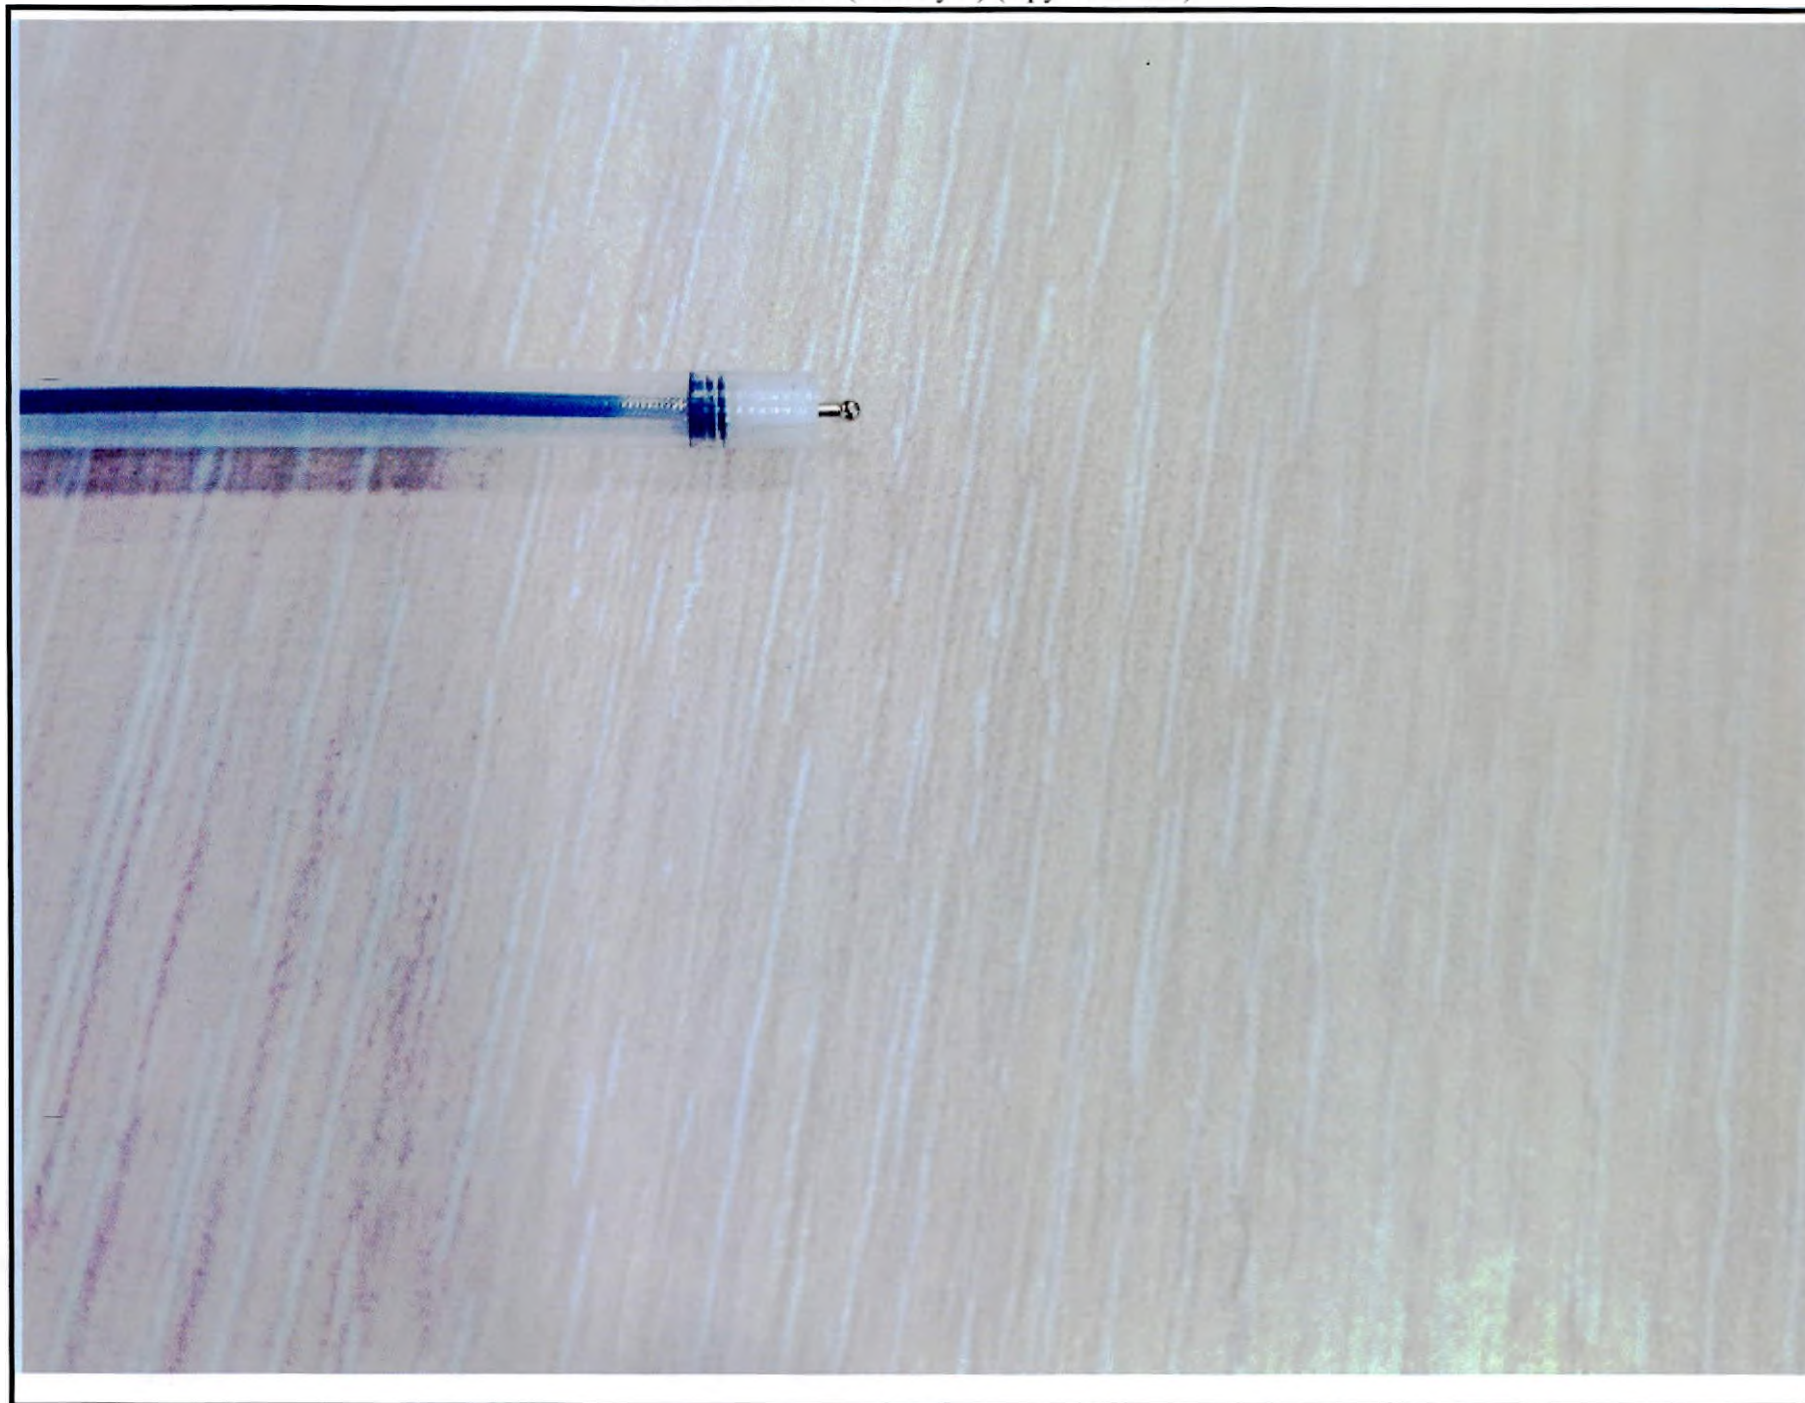


22. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623JI-B20- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)

FUJIFILM **FT**

FlushKnife **BTS** **DK2623JI -B20-**

Diathermic Slitter



2.7mm
2.0mm



≥2.8mm
2300mm

en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2300mm
de : Arbeitslänge : 2300mm
fr : Longueur utile : 2300mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2300mm
es : Longitud de trabajo : 2300mm
pt : Comprimento de trabalho : 2300mm
nl : Werklengte : 2300mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2300mm



1 pc.

STERILE EO

CE 0123

2018-03

2015-04

LOT 1504A1

MADE IN JAPAN

GS1-128



(01) XXXXXXXXXXXXXX (17) XXXXXX (10) XXXXXX

DK2623JI -B20- FF948A PI-1

405Y200891B LN 20180331 1504A1

22. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623JI-B20- (1 шт./уп.) (общий вид упаковки/картонной коробки)



22. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623JI-B20- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)

FUJIFILM

FlushKnife **BTs**

DK2623JI -B20-

Diathermic Slitter

(FT)

2.7mm
2.0mm

2300mm

en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 2300mm
de : Arbeitslänge : 2300mm
fr : Longueur utile : 2300mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 2300mm
es : Longitud de trabajo : 2300mm
pt : Comprimento de trabalho : 2300mm
nl : Werklength : 2300mm
tr : Çalışma uzunluğu : 2300mm

GS1-128

(01) XXXXXXXXXXXXX (17) XXXXXX (10) XXXXXX

DK2623JI -B20- FF948A PI-1

405Y200891B

STERILE EO

CE 0123

2018-03

2015-04


LOT 1504A1

MADE IN JAPAN


1504A1



22. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623JI-B20- (1 шт./уп.)

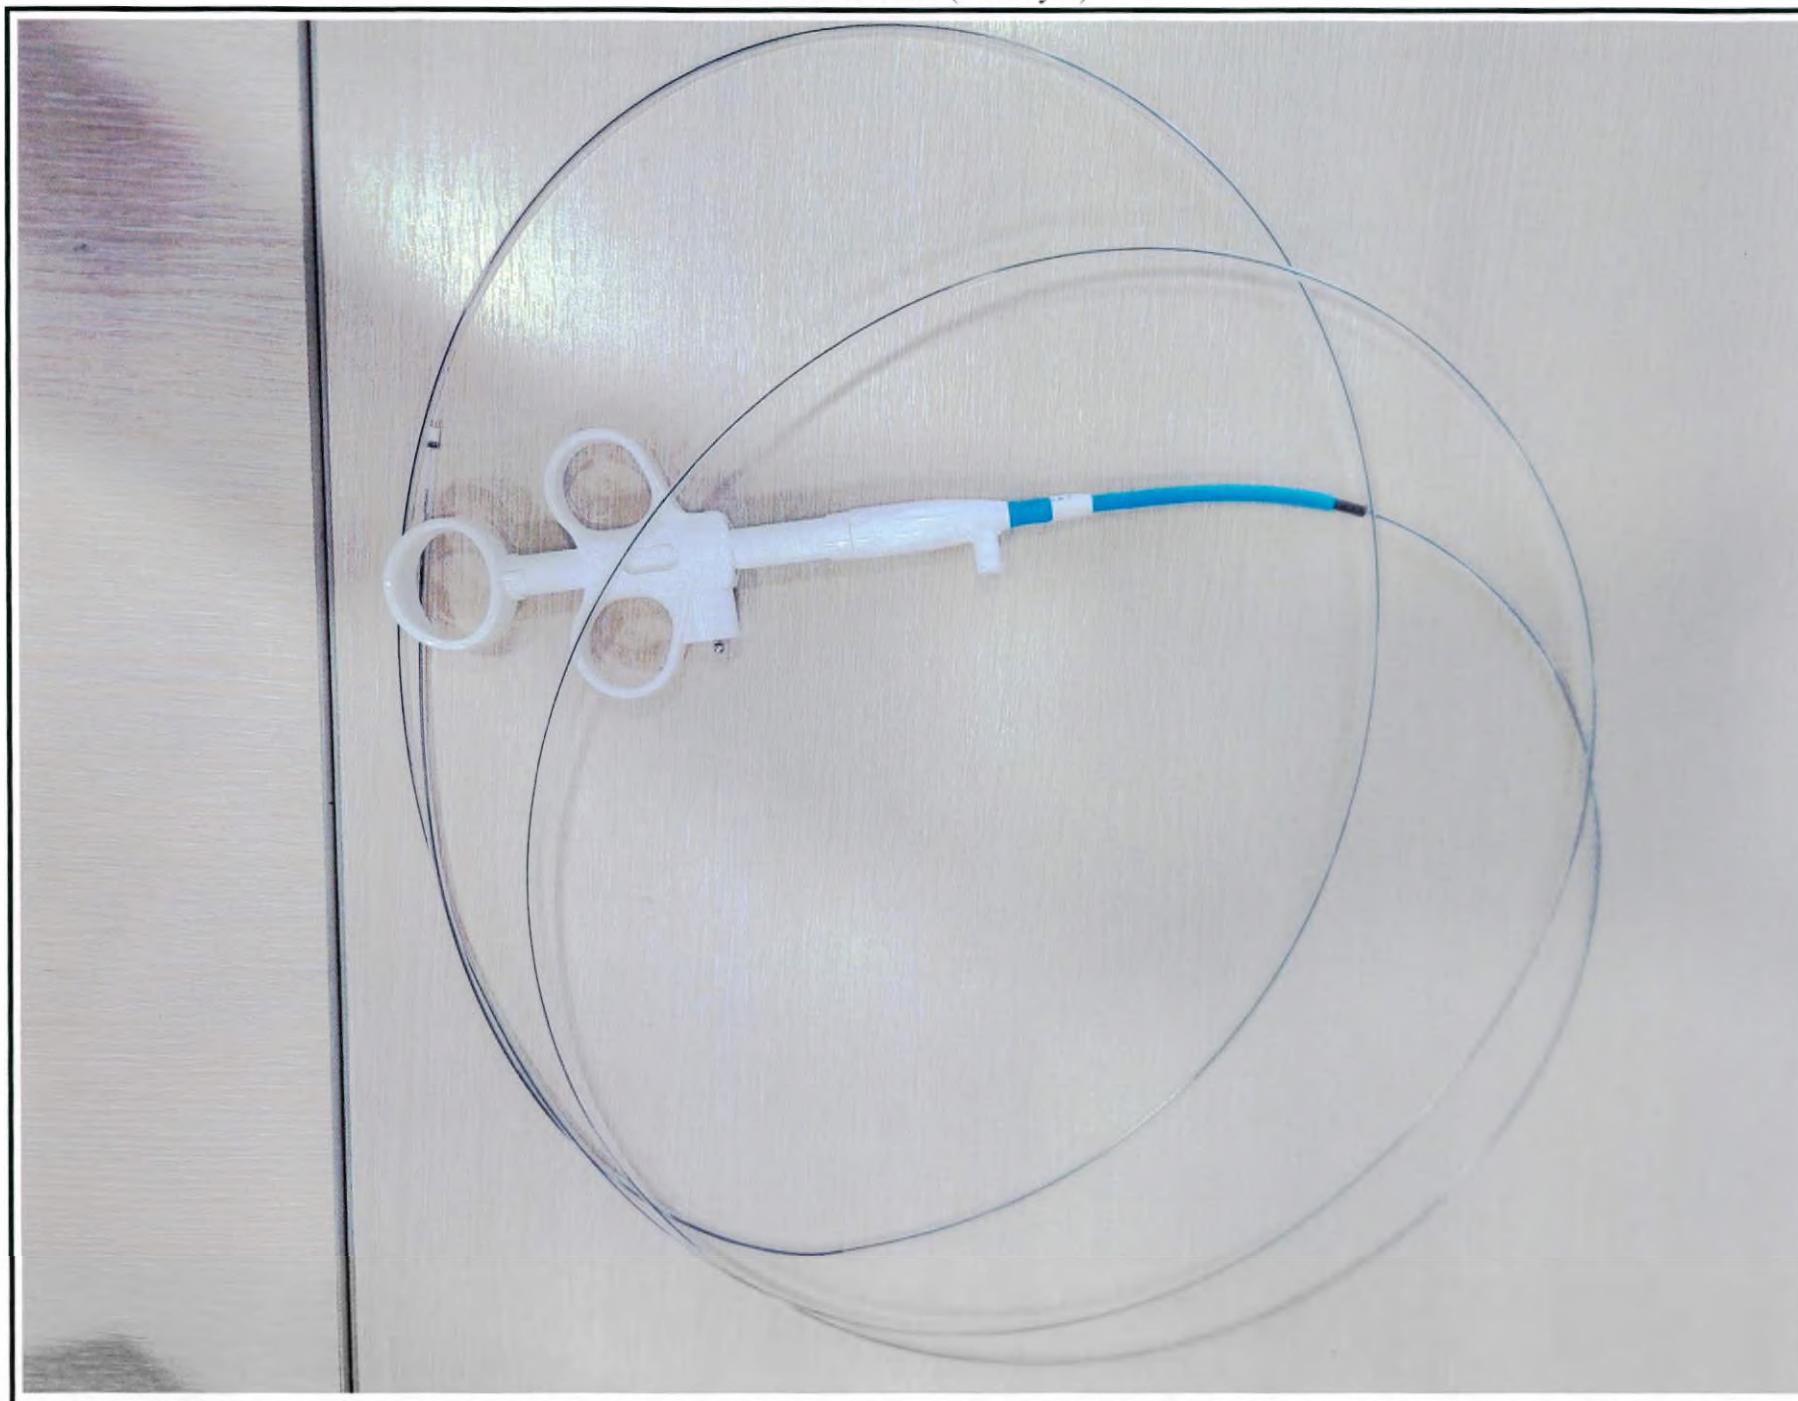


22. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DK2623JI-B20- (1 шт./уп.) (Круглый тип)

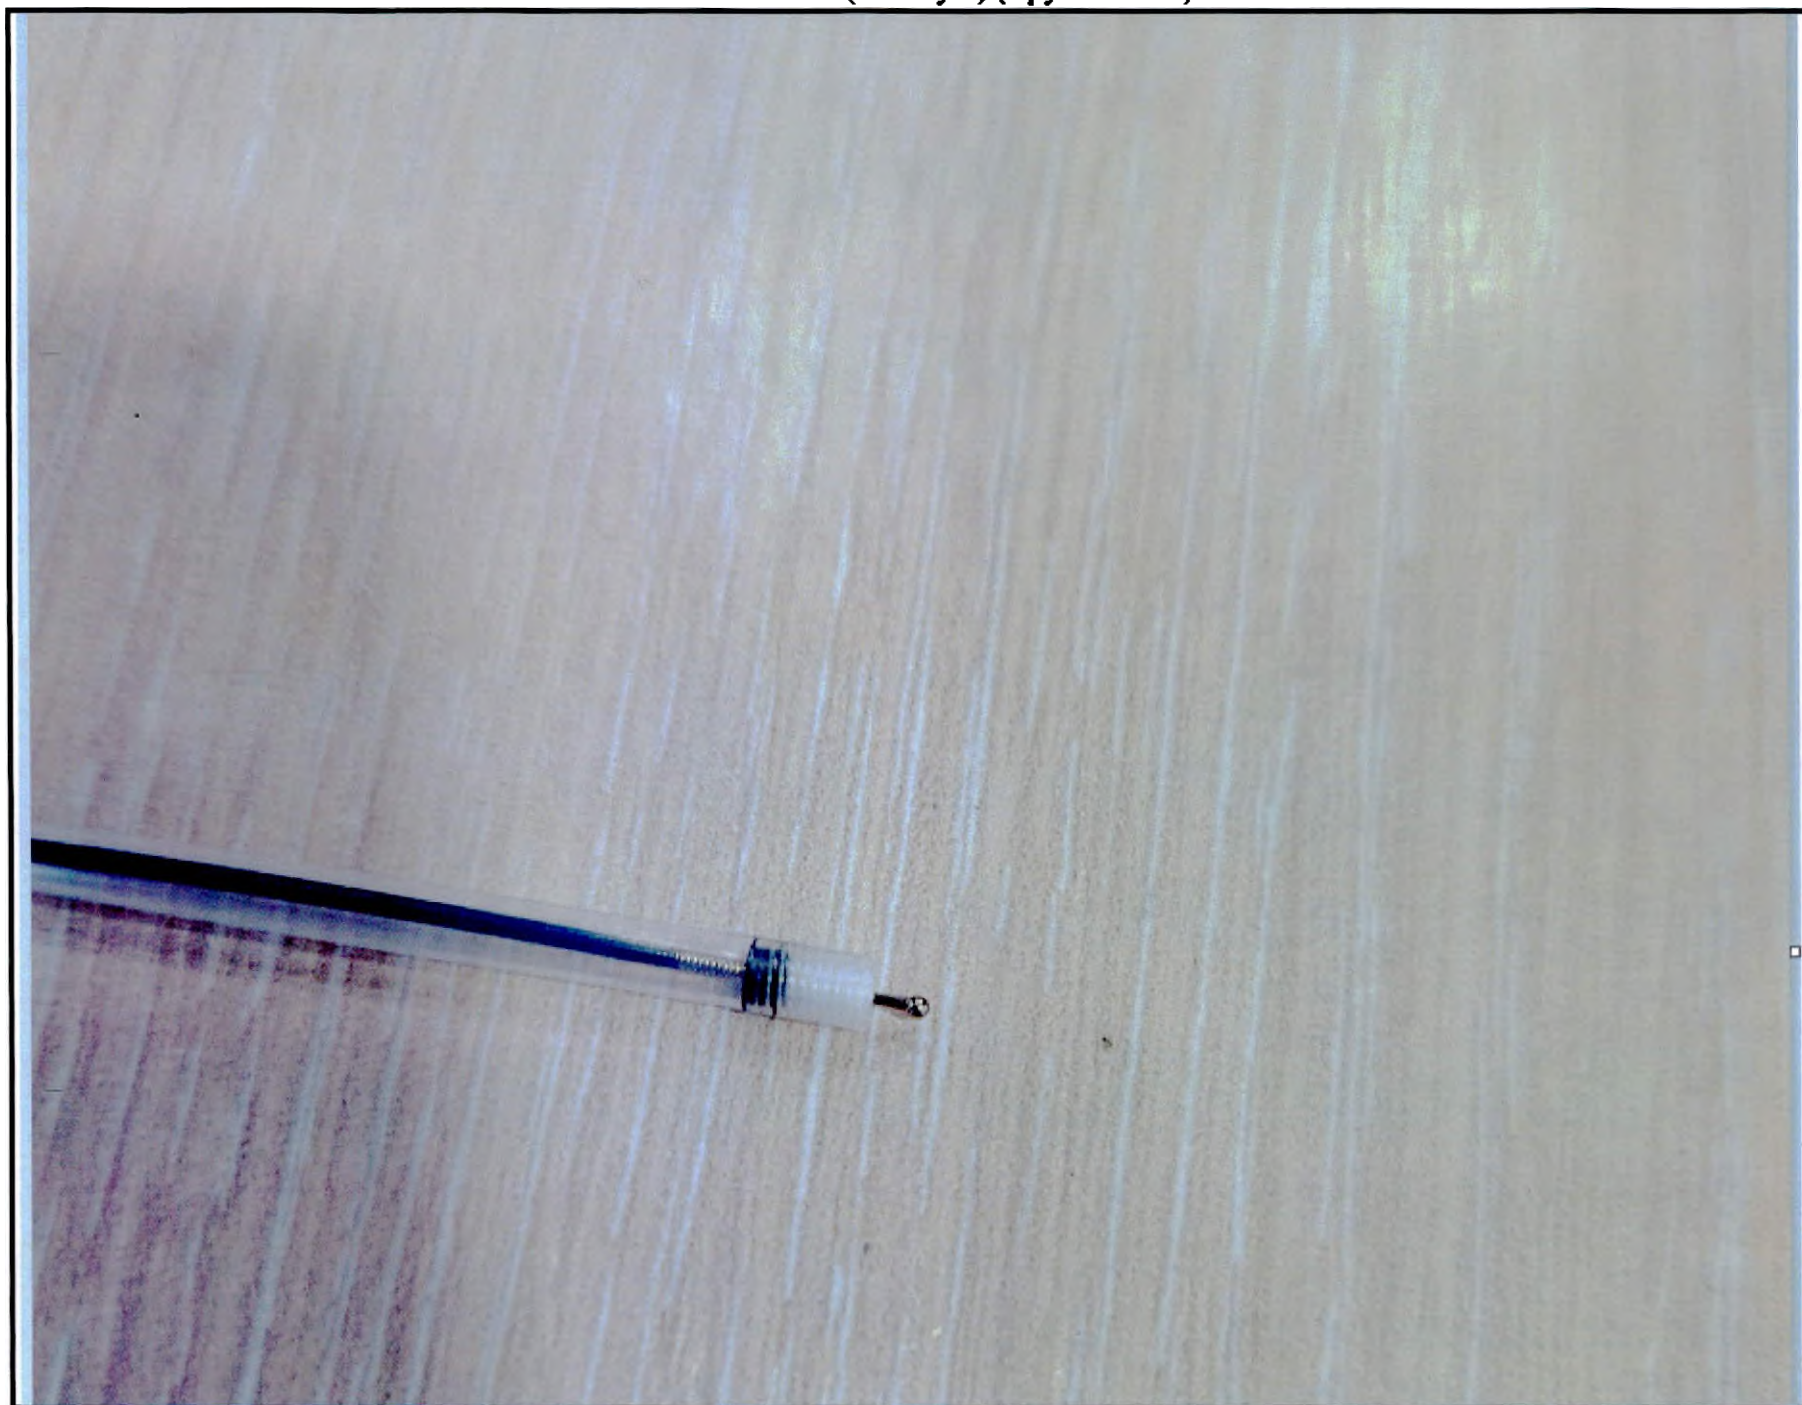

23. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DP2618DT-35- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)

FUJIFILM **ClutchCutter DP2618DT -35-** **(FT)**
Diathermic Slitter




3.5mm



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturi diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥2.8mm

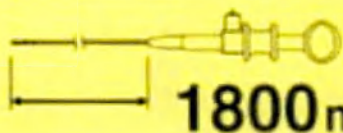

1800mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 1800mm
de : Arbeitslänge : 1800mm
fr : Longueur utile : 1800mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 1800mm
es : Longitud de trabajo : 1800mm
pt : Comprimento de trabalho : 1800mm
nl : Werklength : 1800mm
tr : Çalışma uzunluğu : 1800mm

1 pc.

en : Stored in a package box
de : In einer Produktverpackung aufbewahrt
fr : Rangé dans une boîte d'emballage
it : Conservato in una scatola della confezione
es : Almacenado en un embalaje
pt : Guardado numa embalagem
nl : Opgeslagen in een bewaardoos
tr : Ambalajda saklı

en : Sterile EO
fr : STÉRILE EO
it : STERILE EO
es : STÉRILE EO
pt : STÉRILE EO
nl : STERILE EO
tr : STERILE EO

CE 0123


2016-11

2013-12

LOT 1312A1

MADE IN JAPAN

23. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DP2618DT-35- (1 шт./уп.) - (общий вид упаковки/картонной коробки)

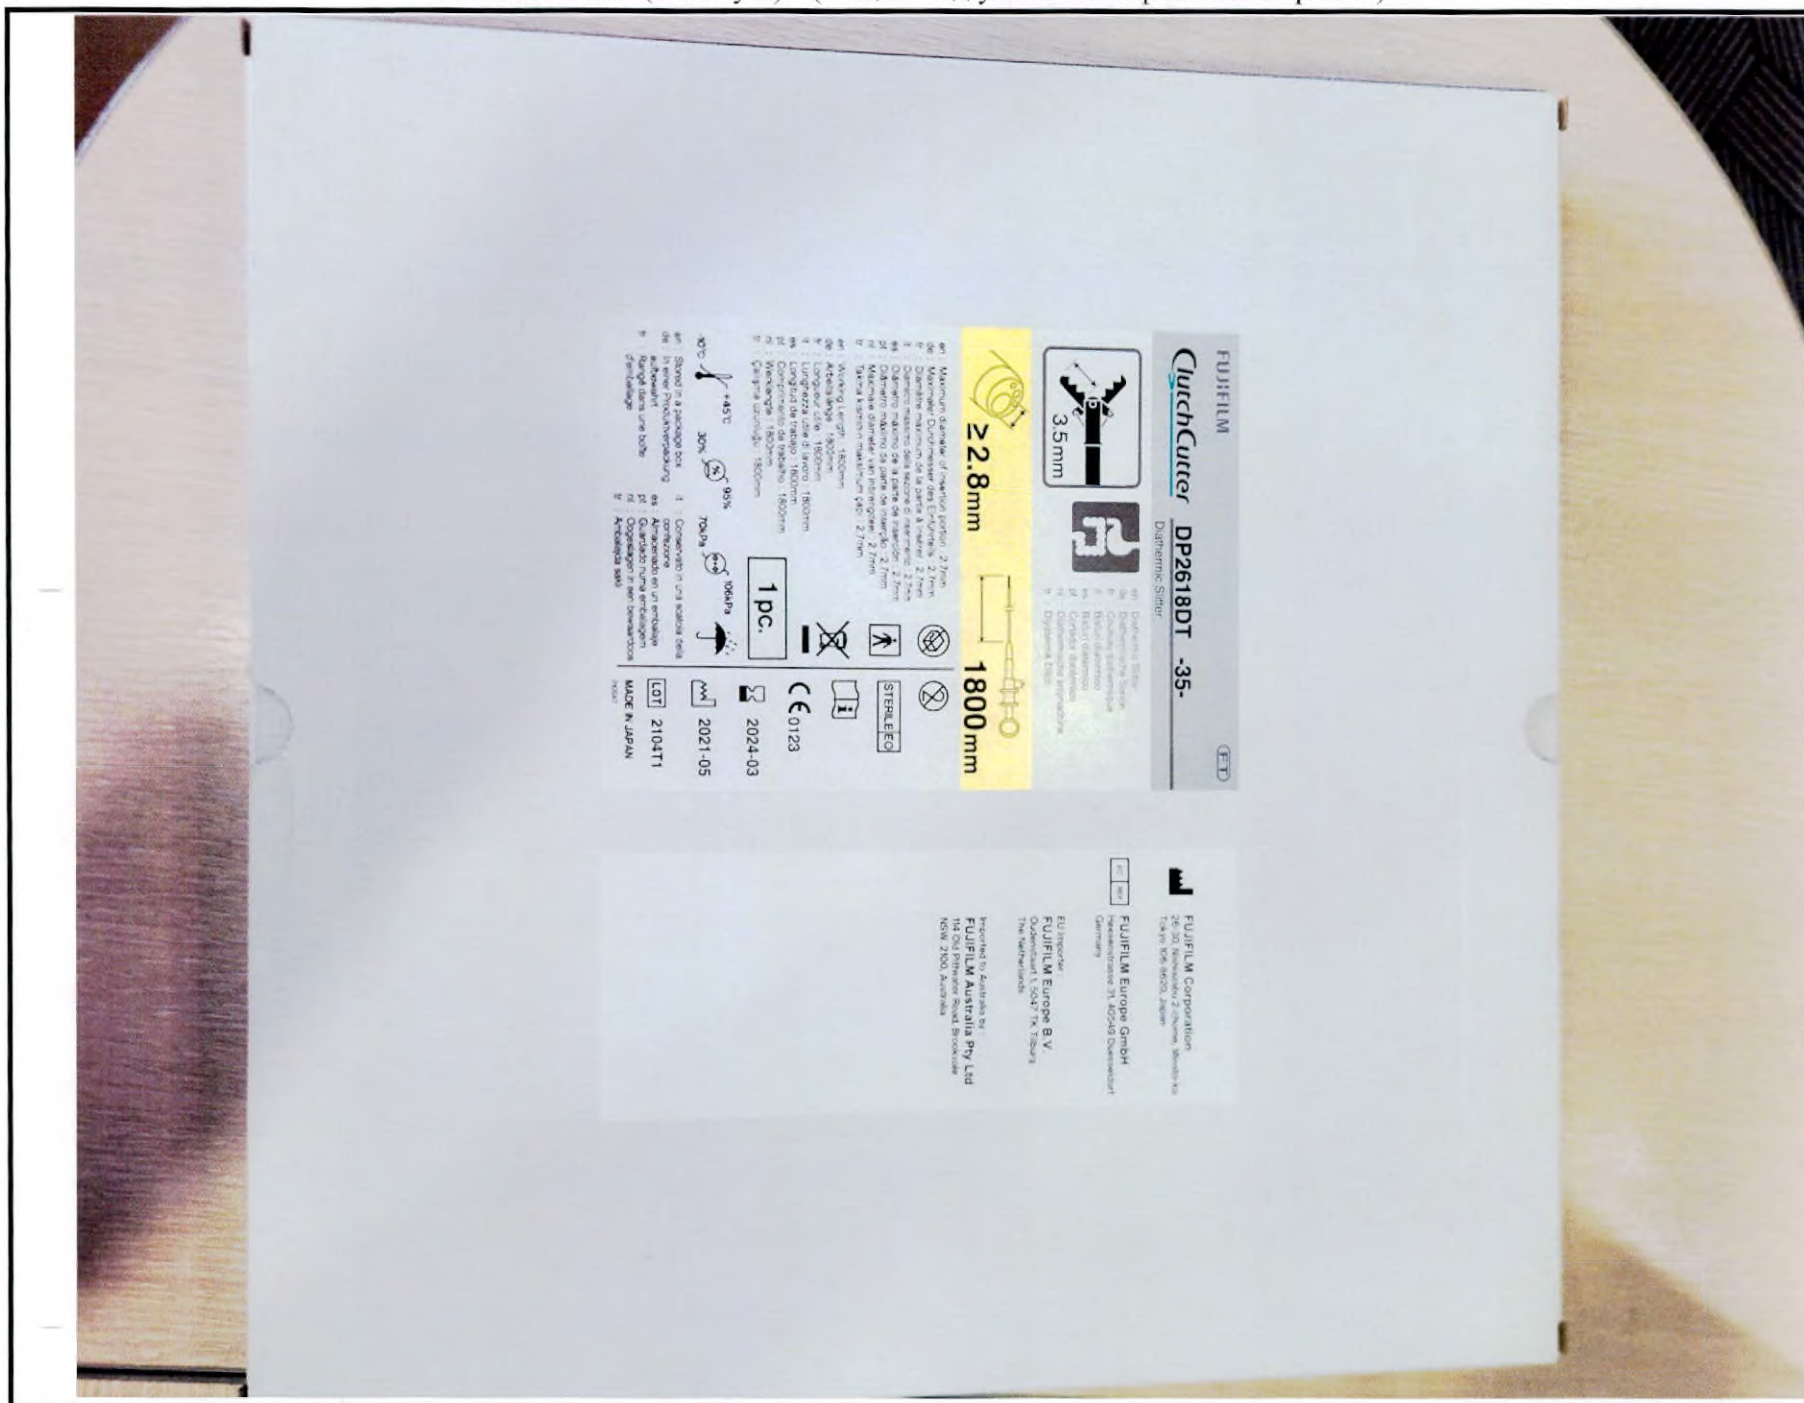


23. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DP2618DT-35- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)

FUJIFILM
FT



DP2618DT -35-

Diathermic Slitter




3.5mm



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturí diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥2.8mm



1800mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 1800mm
de : Arbeitslänge : 1800mm
fr : Longueur utile : 1800mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 1800mm
es : Longitud de trabajo : 1800mm
pt : Comprimento de trabalho : 1800mm
nl : Werklengte : 1800mm
tr : Çalışma uzunluğu : 1800mm








STERILE



CE 0123

2016-11

2013-12

LOT 1312A1

MADE IN JAPAN

GS1-128




(01) 04547410324075 (17) 161100 (10) 1312A1

DP2618DT -35- FF825A PI-0

23. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DP2618DT-35- (1 шт./уп.) - стерильная упаковка



23. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DP2618DT-35- (1 шт./уп.)

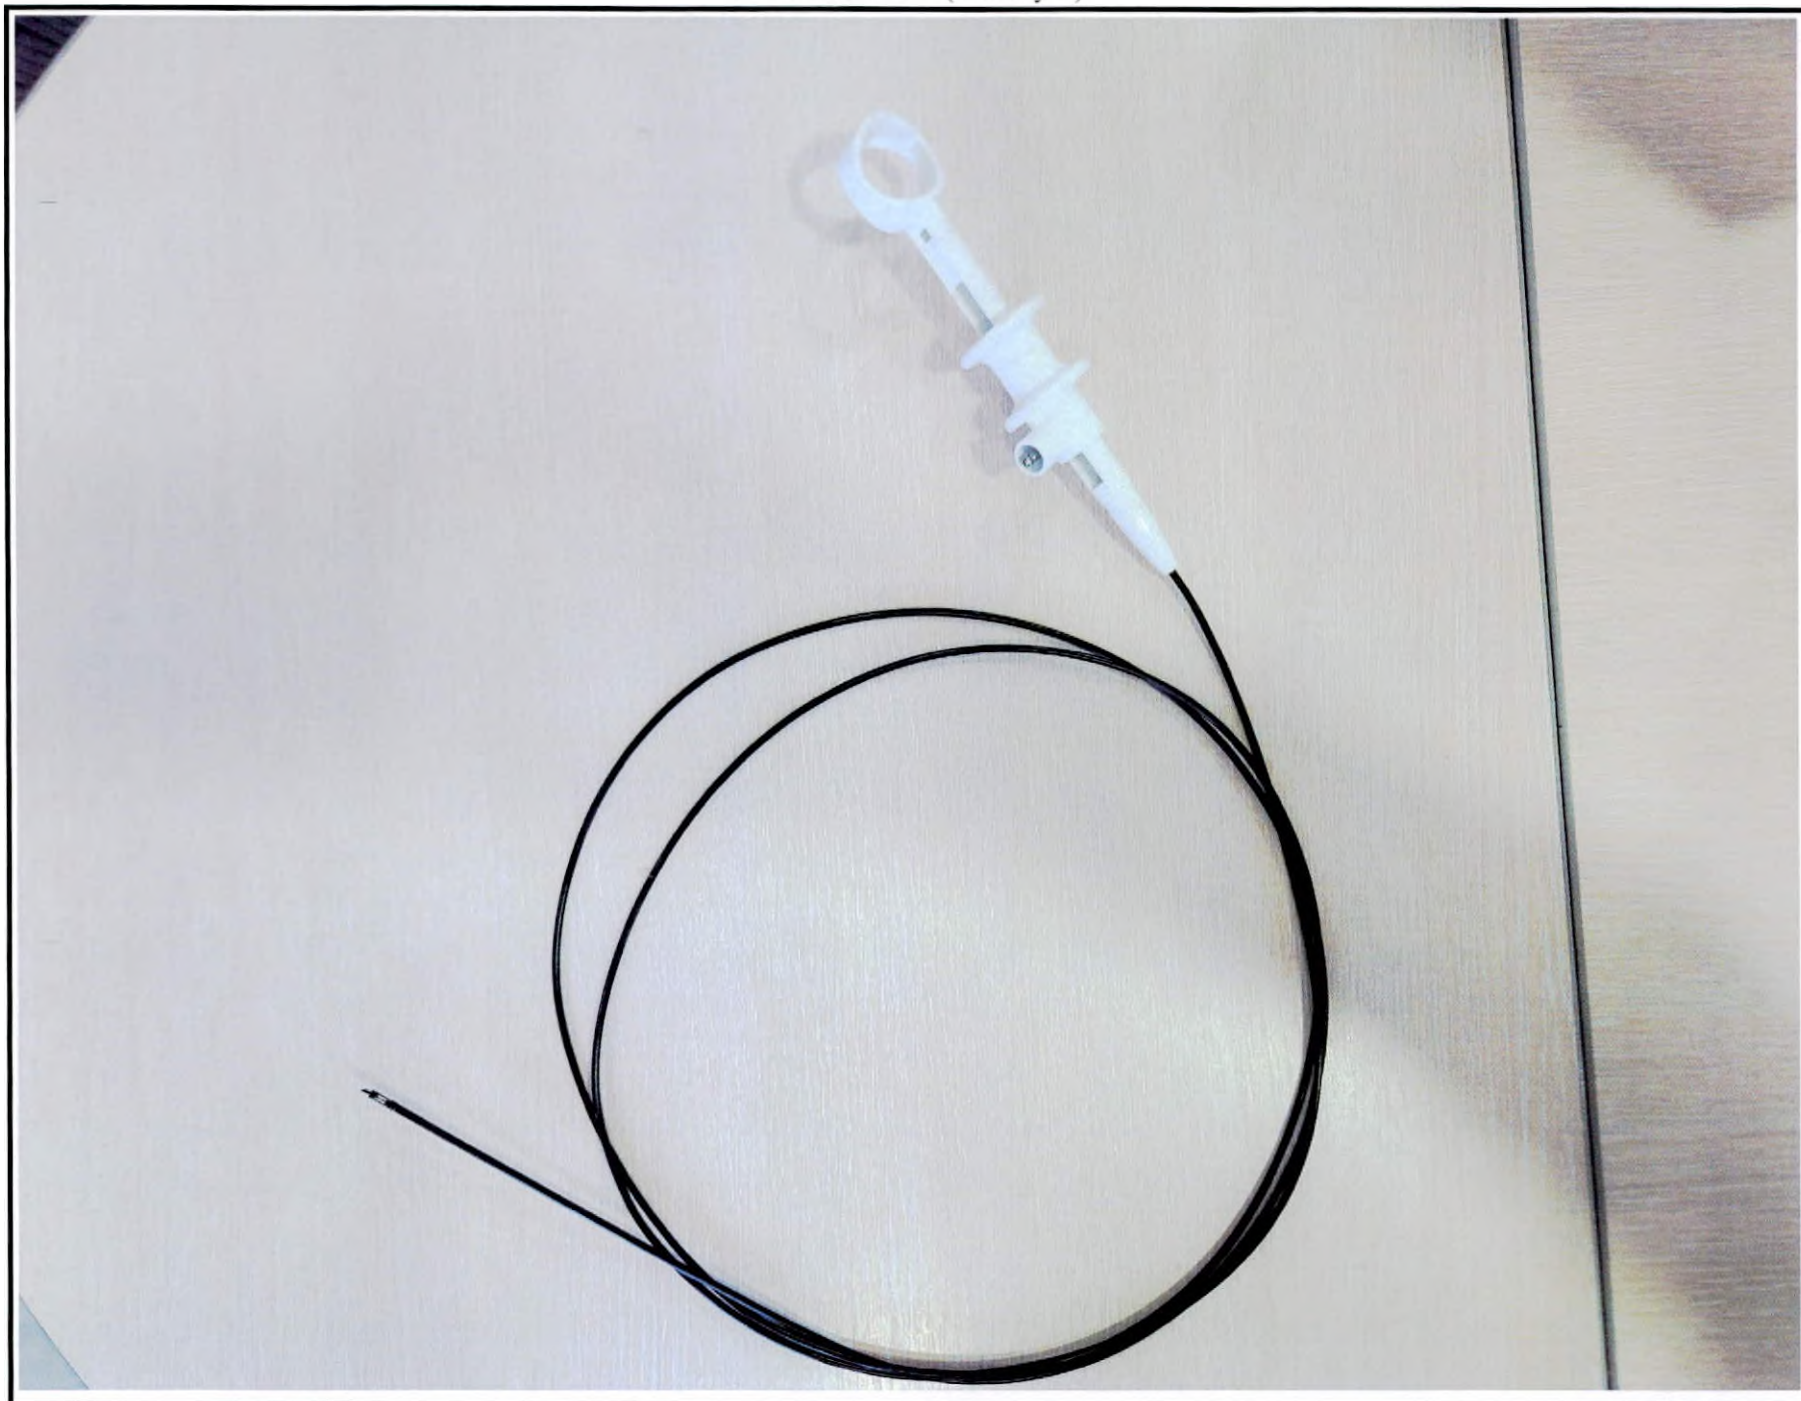


23. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DP2618DT-35- (1 шт./уп.) (зажим)



24. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки
DP2618DT-50- (1 шт./уп.) - (Маркировка на картонной коробке)

FUJIFILM (FT)

ClutchCutter DP2618DT -50-
 Diathermic Slitter



5.0 mm



en : Diathermic Slitter
 de : Diathermische Sonde
 fr : Couteau diathermique
 it : Bisturi diatermico
 es : Bisturí diatérmico
 pt : Cortador diatérmico
 nl : Diathermische snijmachine
 tr : Diyatermik Dilici



≥2.8 mm



1800 mm

en : Maximum diameter of insertion portion : 2.7 mm
 de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7 mm
 fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7 mm
 it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7 mm
 es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7 mm
 pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7 mm
 nl : Maximale diameter van inbrengdeel : 2.7 mm
 tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7 mm

en : Working Length : 1800 mm
 de : Arbeitslänge : 1800 mm
 fr : Longueur utile : 1800 mm
 it : Lunghezza utile di lavoro : 1800 mm
 es : Longitud de trabajo : 1800 mm
 pt : Comprimento de trabalho : 1800 mm
 nl : Werklengte : 1800 mm
 tr : Çalışma uzunluğu : 1800 mm








STERILE EO




CE 0123


2025-03-31

2022-04-01

1 pc.



-10°C +45°C



30% 95%



70 kPa 106 kPa



en : Stored in a package box
 de : In einer Produktverpackung aufbewahrt
 fr : Rangé dans une boîte d'emballage


it : Conservato in una scatola della confezione
 es : Almacenado en un embalaje
 pt : Guardado numa embalagem
 nl : Opgeslagen in een bewaardoos
 tr : Ambalajda saklı

LOT 2204A1

MADE IN JAPAN

1312A1

24. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения DP2618DT-50-
(1 шт./уп.) - (общий вид упаковки/картонной коробки)

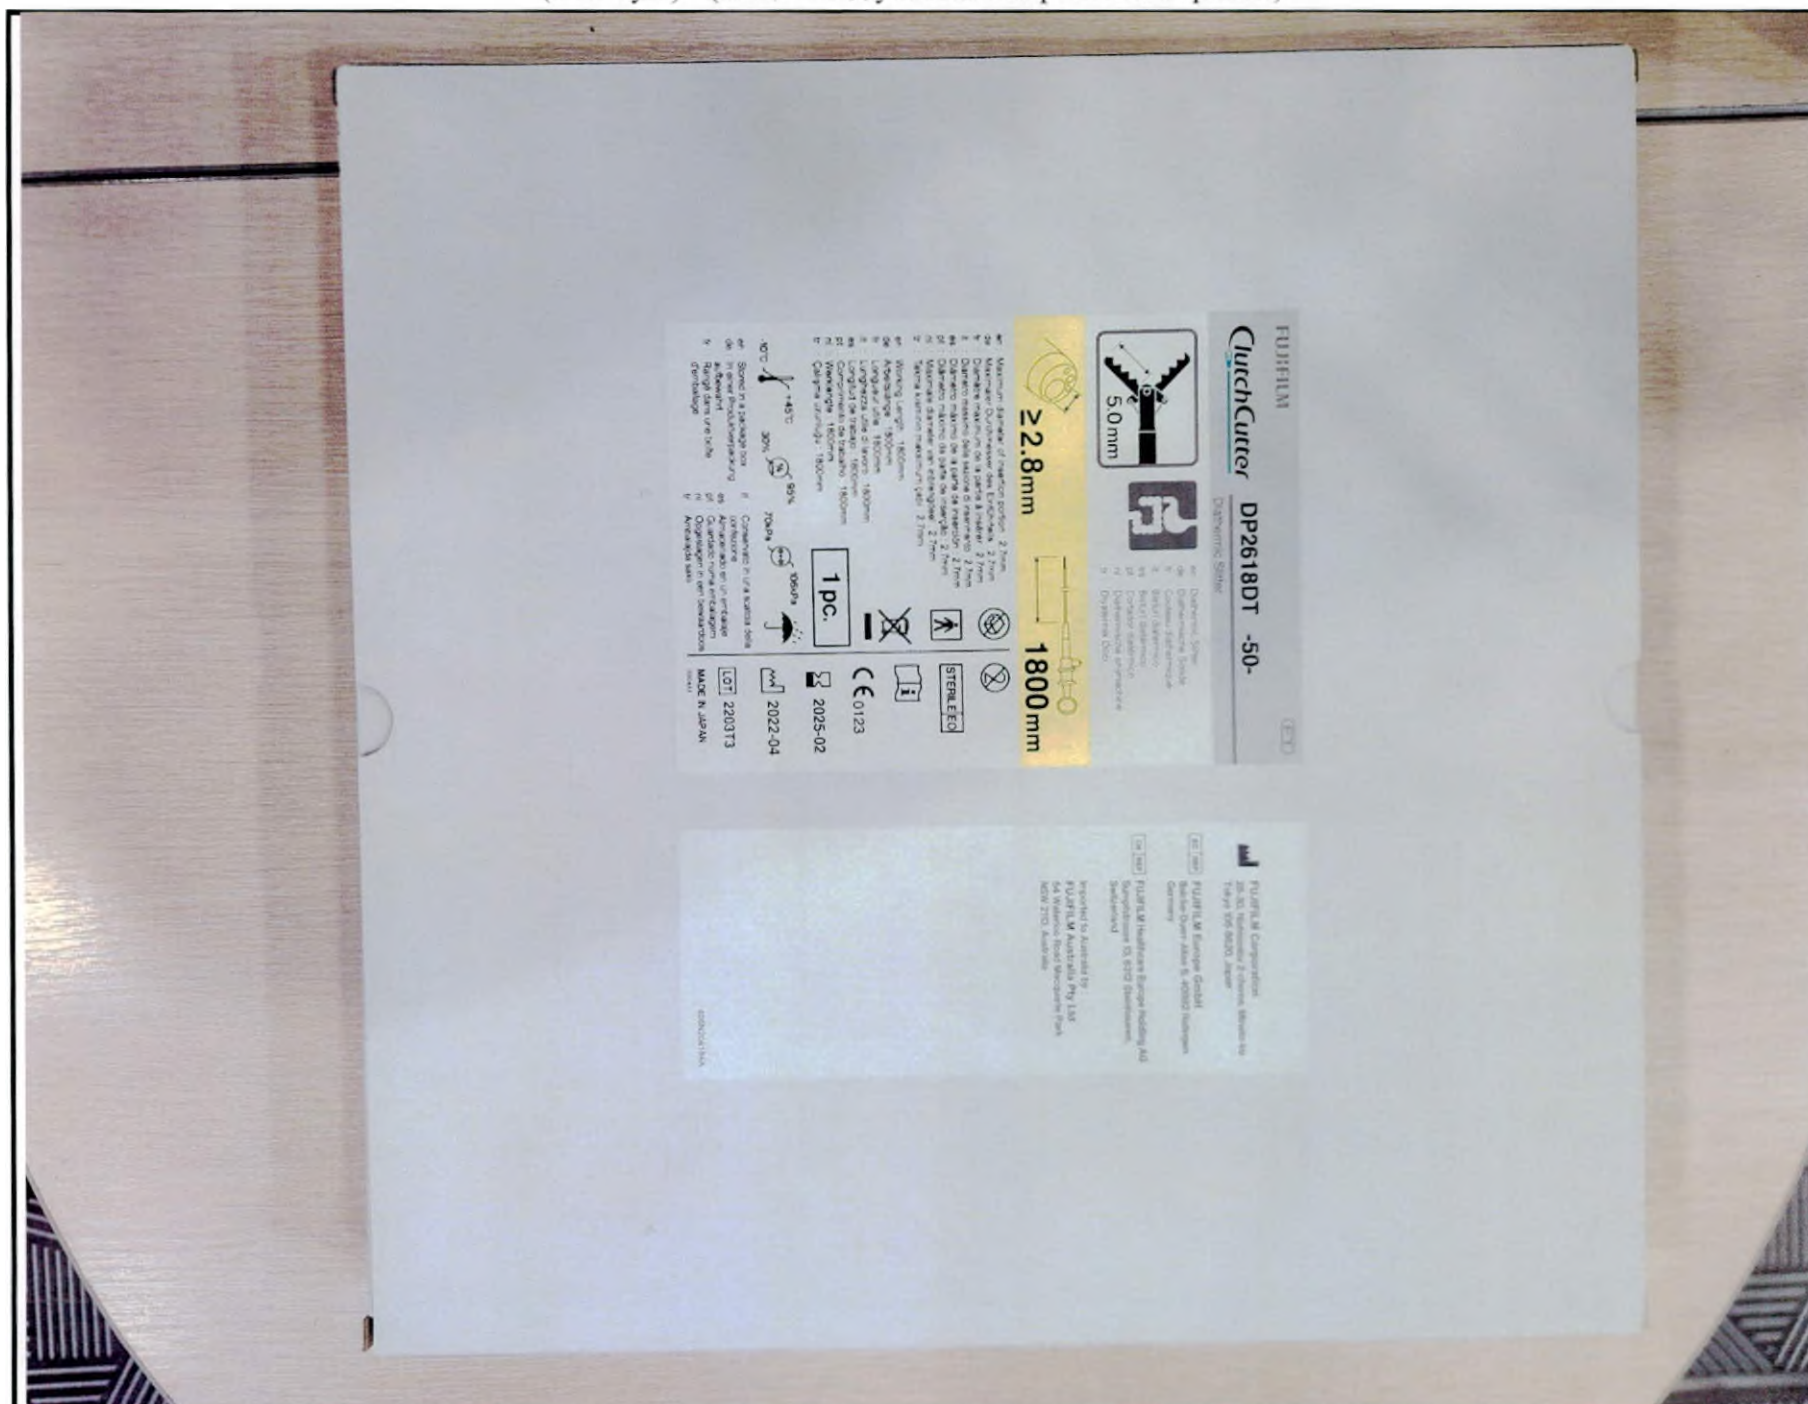


24. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DP2618DT-50- (1 шт./уп.) - (Маркировка на стерильной упаковке)

FUJIFILM
(FT)

ClutchCutter DP2618DT -50-

Diathermic Slitter



5.0mm



en : Diathermic Slitter
de : Diathermische Sonde
fr : Couteau diathermique
it : Bisturi diatermico
es : Bisturi diatérmico
pt : Cortador diatérmico
nl : Diathermische snijmachine
tr : Diyatermik Dilici



≥2.8mm



1800mm

en : Maximum diameter of Insertion portion : 2.7mm
de : Maximaler Durchmesser des Einführteils : 2.7mm
fr : Diamètre maximum de la partie à insérer : 2.7mm
it : Diametro massimo della sezione di inserimento : 2.7mm
es : Diámetro máximo de la parte de inserción : 2.7mm
pt : Diâmetro máximo da parte de inserção : 2.7mm
nl : Maximale diameter van Inbrengdeel : 2.7mm
tr : Takma kısmının maksimum çapı : 2.7mm

en : Working Length : 1800mm
de : Arbeitslänge : 1800mm
fr : Longueur utile : 1800mm
it : Lunghezza utile di lavoro : 1800mm
es : Longitud de trabajo : 1800mm
pt : Comprimento de trabalho : 1800mm
nl : Werklength : 1800mm
tr : Çalışma uzunluğu : 1800mm

GS1-128



(01) 04547410324075 (17) 161100 (10) 1312A1
DP2618DT -35- FF825A PT-0









STERILE EO

CE 0123

2025-03-31

2022-04-01

LOT 2204A1


MADE IN JAPAN

1312A1

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



24. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии ткани, остановки кровотечения
DP2618DT-50- (1 шт./уп.)

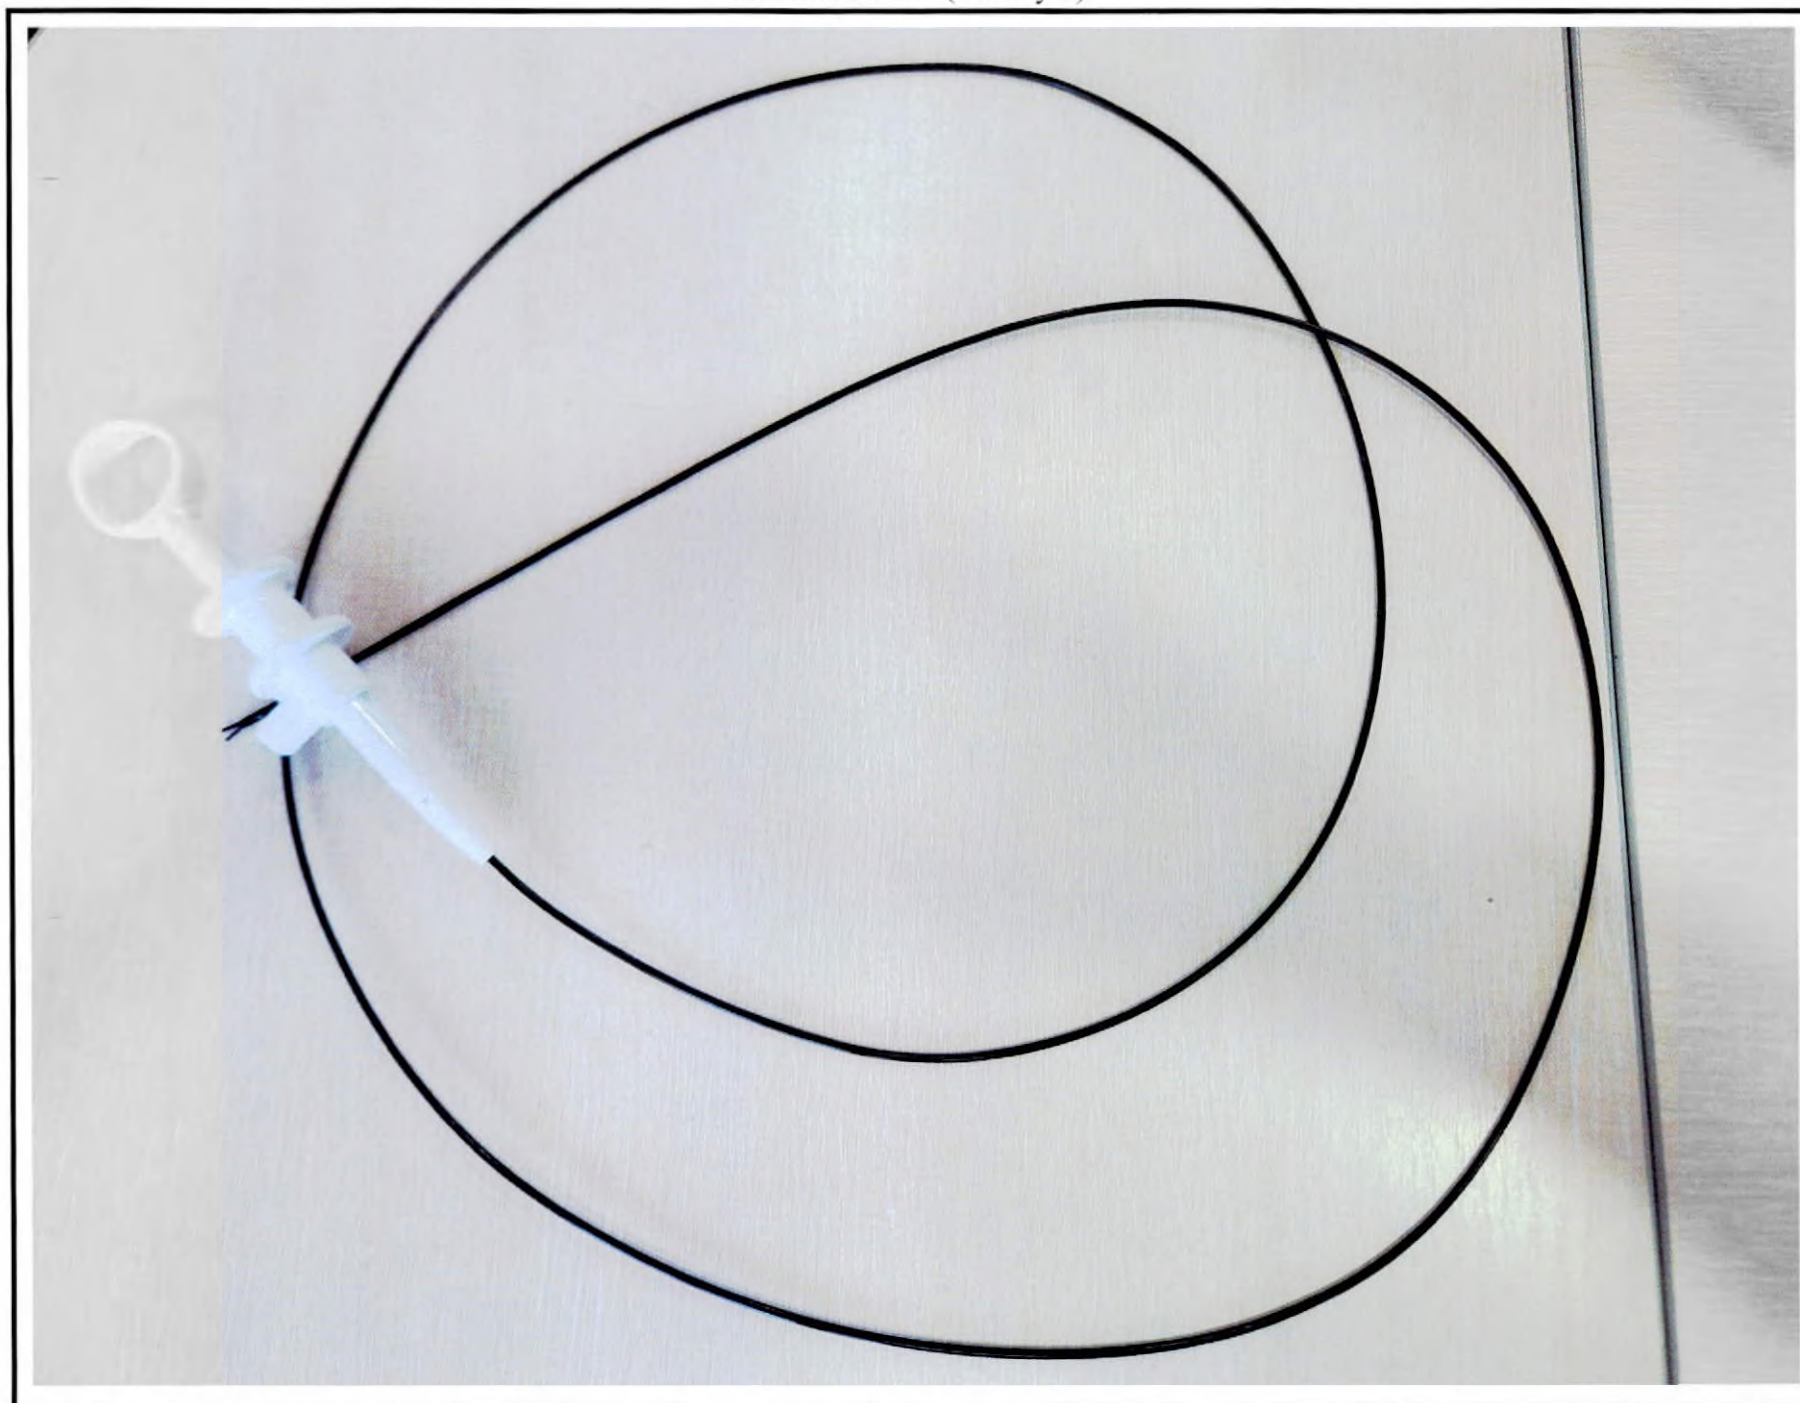

24. Нож для абляции, надреза, иссечения, прижигания, коагуляции, авульсии тканей, остановки кровотечения
DP2618DT-50- (1 шт./уп.) (зажим)



PATIENT CHART	Single Use Diathermic Slitter DK2620JI -N10- FUJIFILM Steriz. Lot : Use by :
INVENTORY CONTROL	Single Use Diathermic Slitter DK2620JI -N10- FUJIFILM Steriz. Lot : Use by :
PATIENT CHARGE	Single Use Diathermic Slitter DK2620JI -N10- FUJIFILM Steriz. Lot : Use by :
1.0_{mm} FlushKnife Ns 1.0_{mm}	
Please stick this label on the instrument.	

150 листов

Подпись

