


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «РУМЭКС Медикал»


Макарова Н.В.
«19» июня 2023 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1126234006821
"РУМЭКС Медикал"
ИНН 6234104738
МОСКВА

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Анализатор переднего отрезка глаза с функцией оптической биометрии Pentacam AXL WAVE





Рисунок 1 – Основной блок.

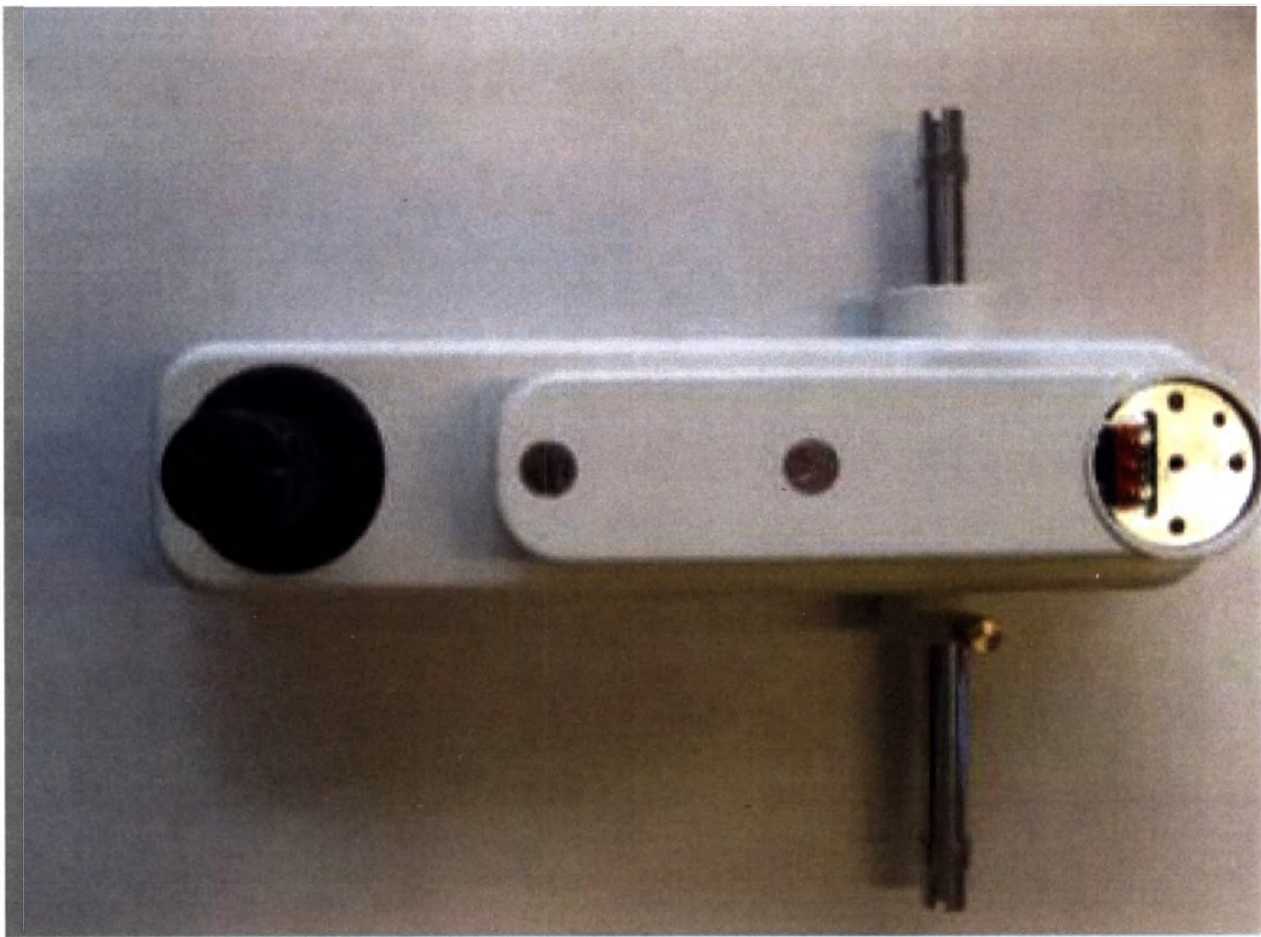


Рисунок 2 – X-Y основание.

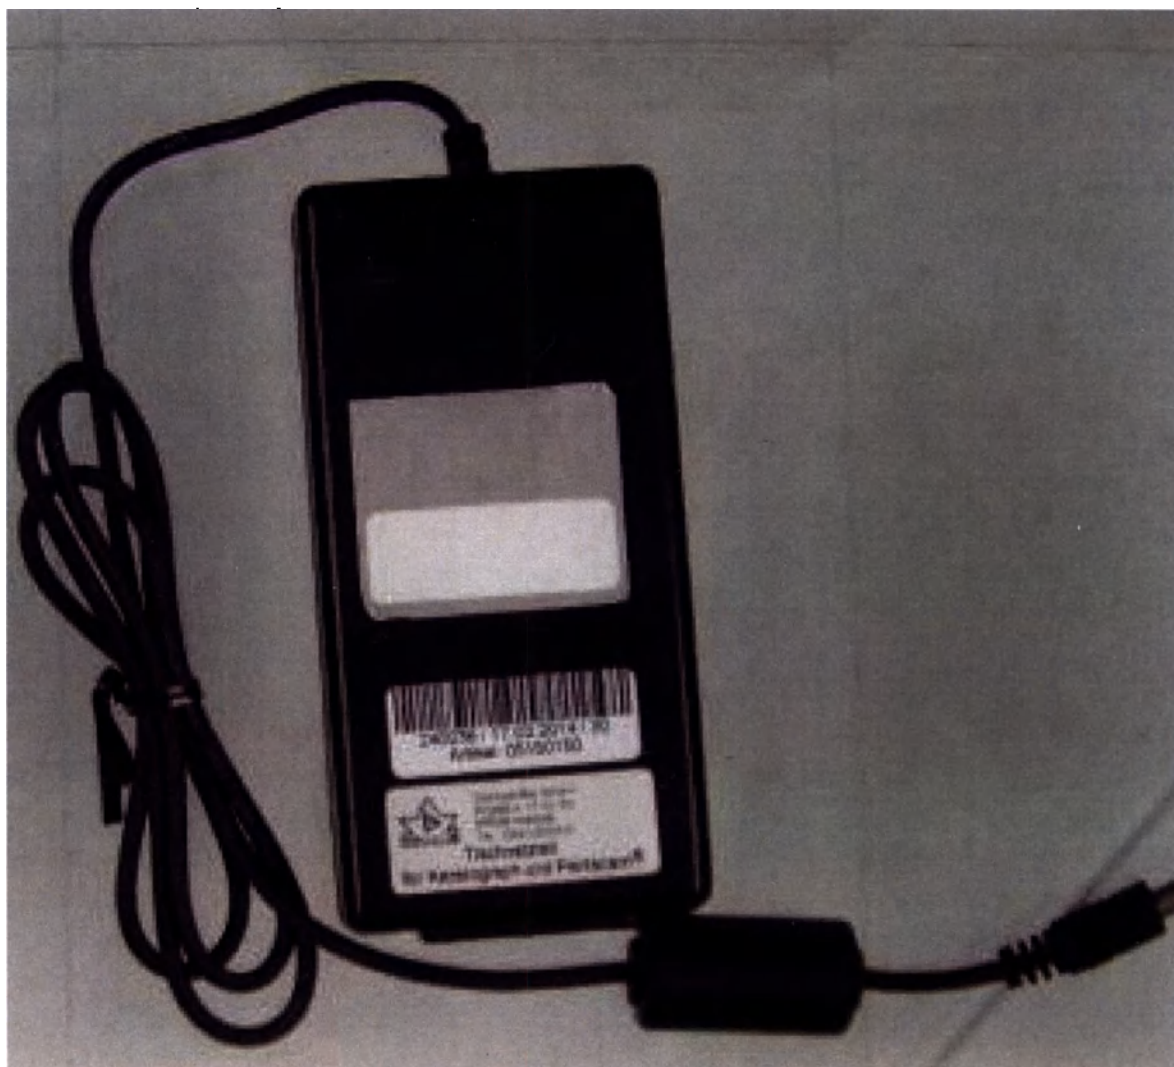


Рисунок 3 – Блок питания.

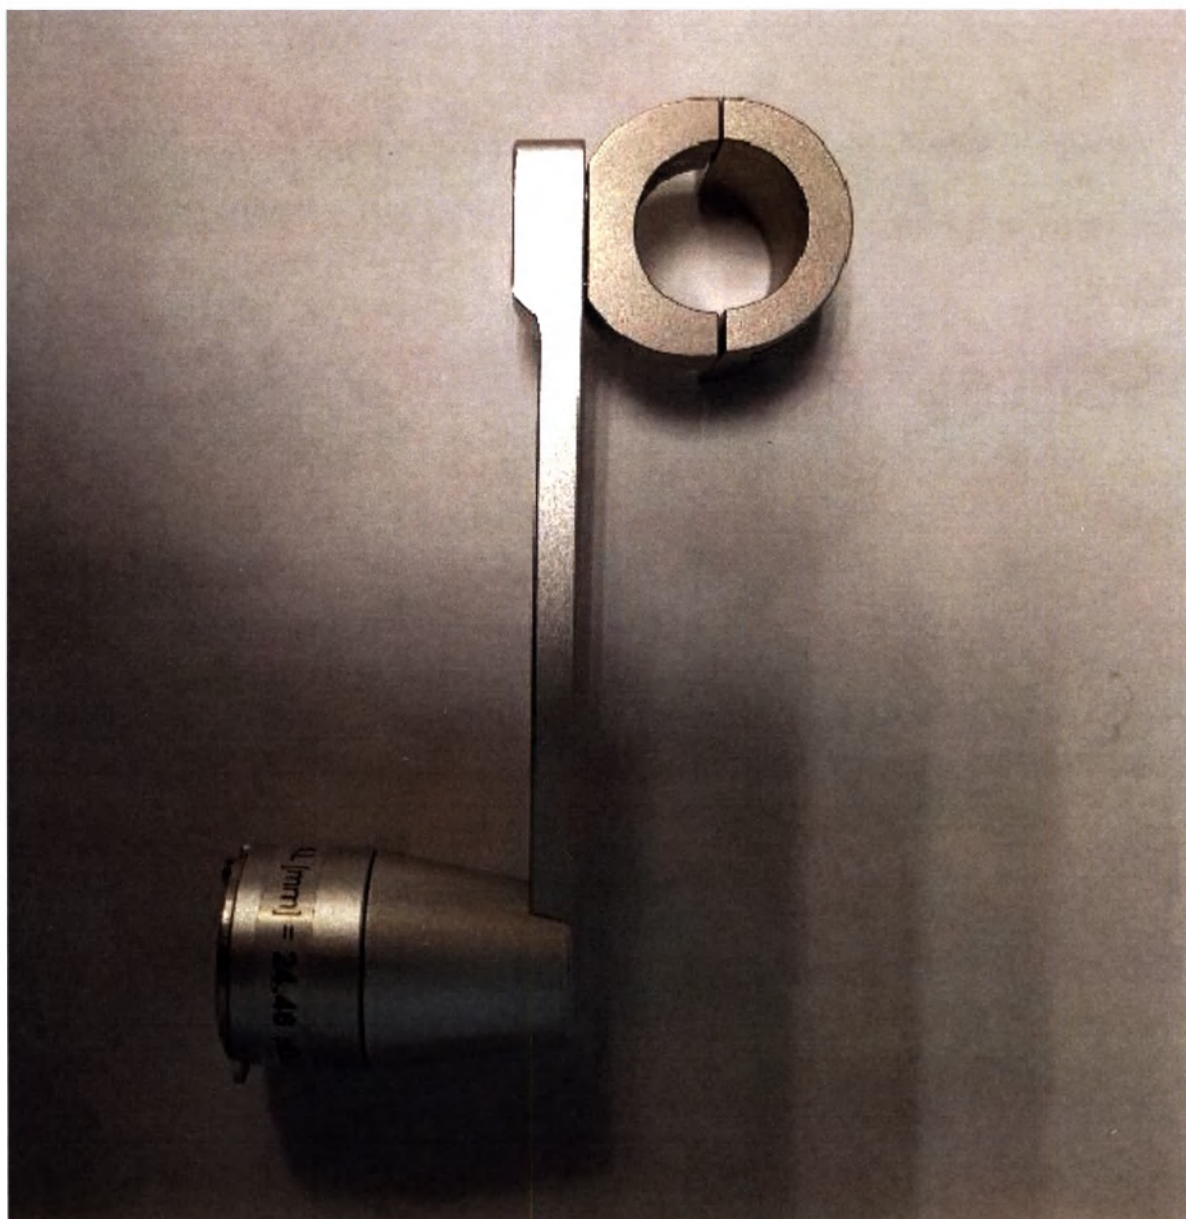


Рисунок 4 – Тестовый глаз.

OCULUS Pentacam AXL Wave



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Анализатор переднего отрезка глаза с функцией оптической биометрии
Pentacam AXL WAVE

Руководство по эксплуатации Pentacam AXL Wave 70020-FN Ред. 061

Рисунок 5 – Руководство по эксплуатации.

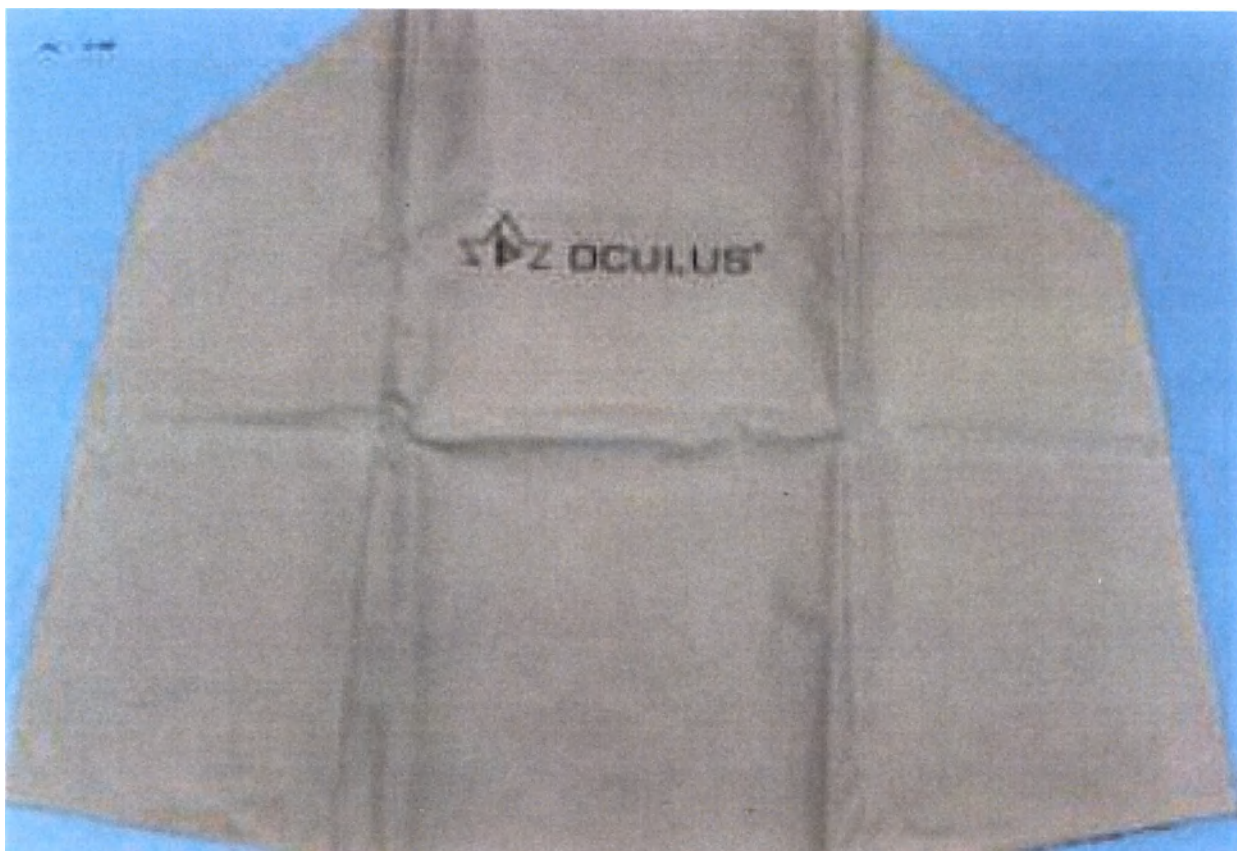


Рисунок 6 – Пылезащитный чехол.



Рисунок 7 – Кабель питания.



Рисунок 8 – Светонепроницаемая материя черного цвета.



Рисунок 9 – Ключ активации изделия.



Рисунок 10 – USB-флеш-накопитель с программным обеспечением.



Рисунок 11 – Y-образный соединительный кабель.



Рисунок 12 – Основание для установки прибора со столом.

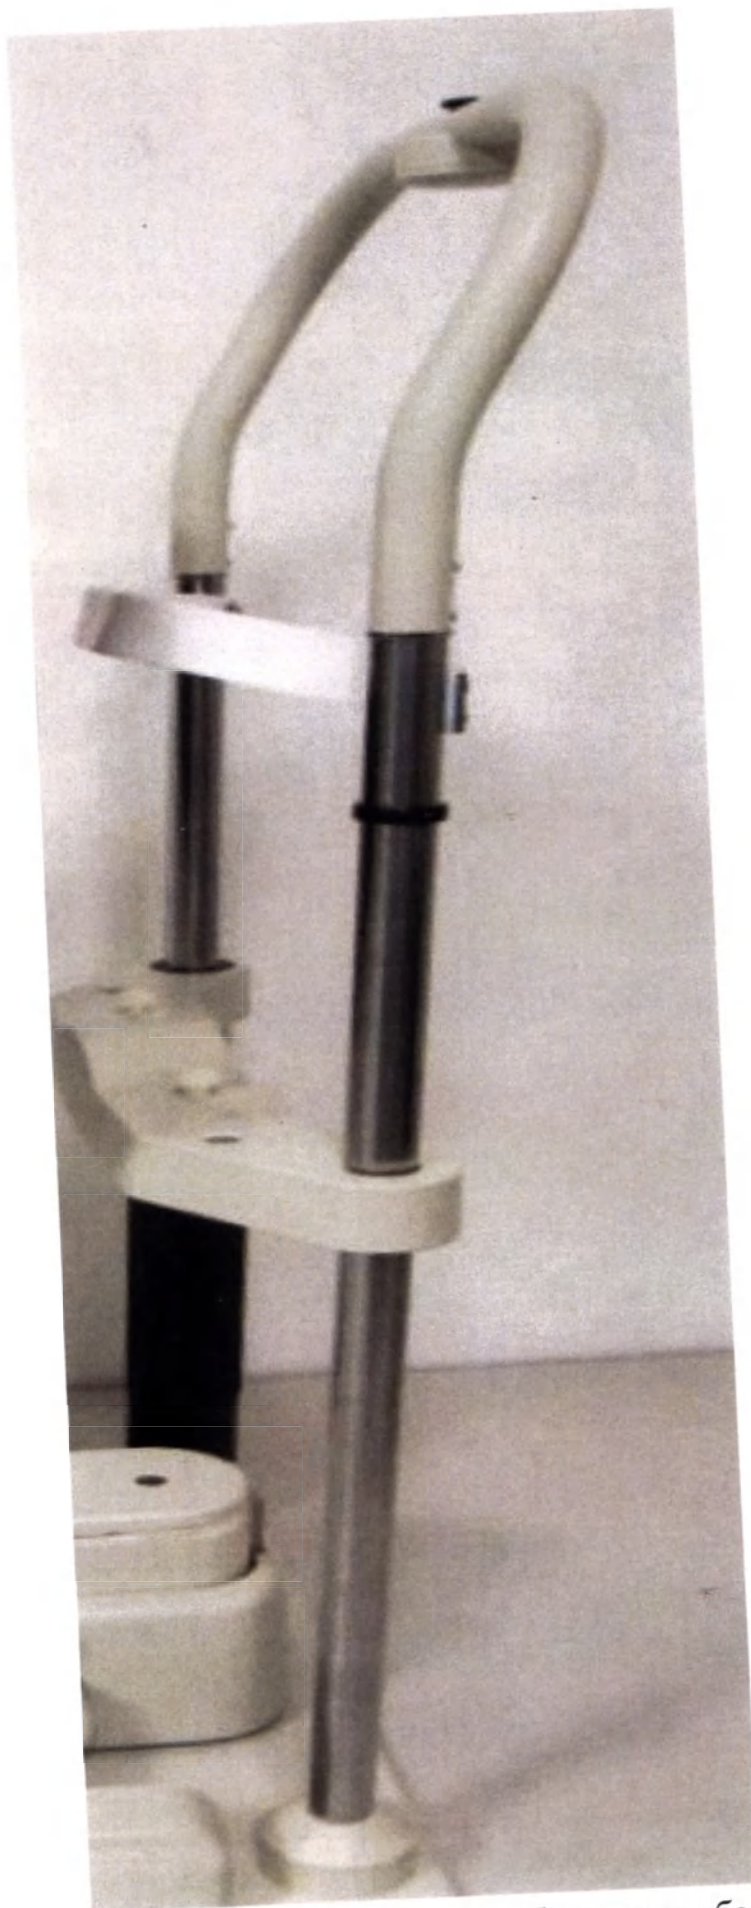


Рисунок 13 – Упор для подбородка и лба.



Рисунок 14 – Фиксатор кабеля.

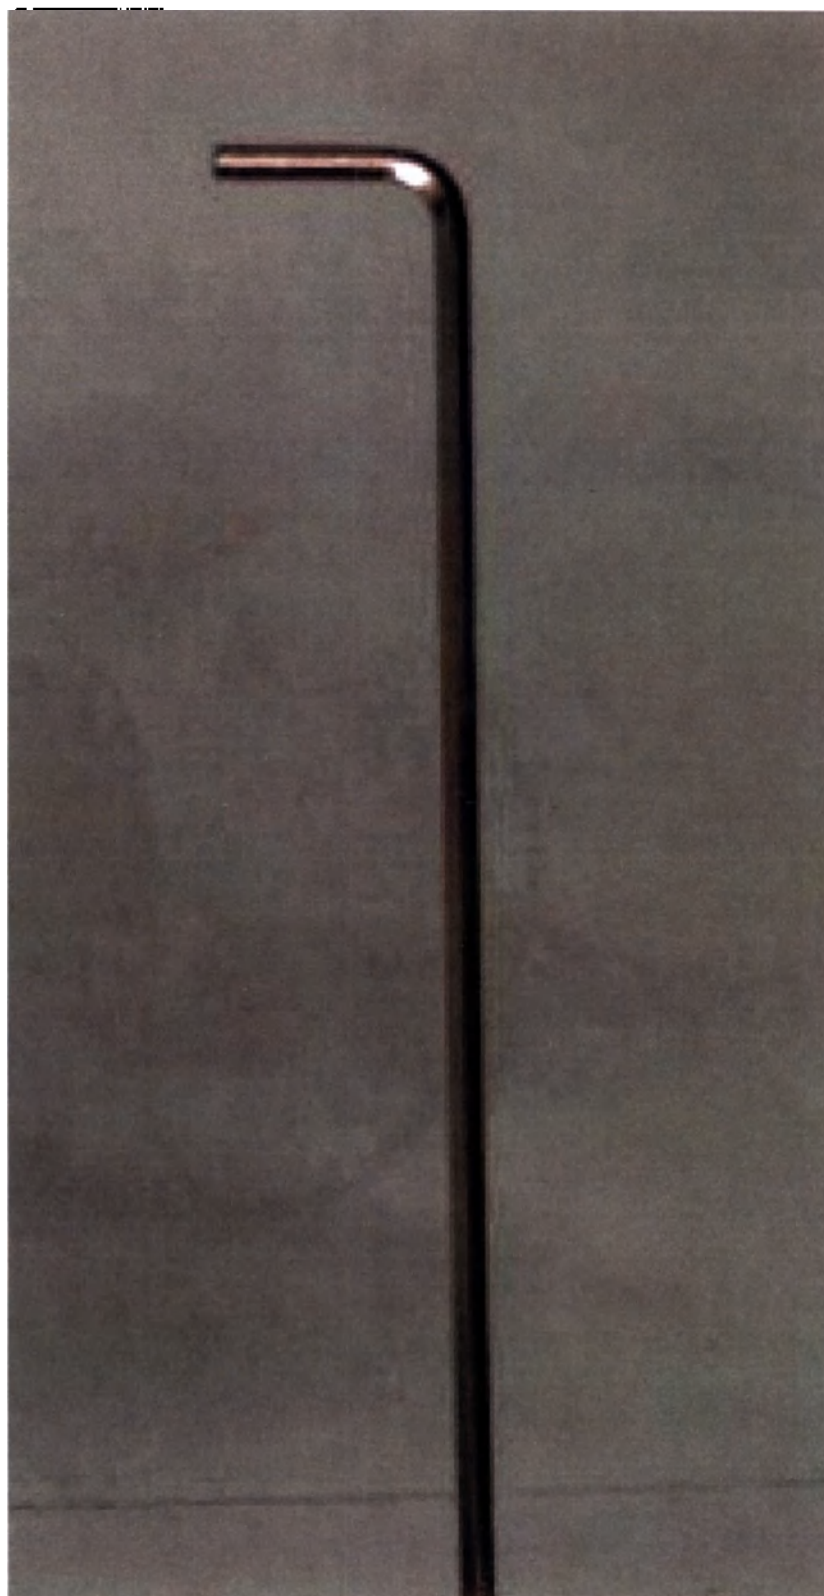


Рисунок 15 – Шестигранная отвертка.

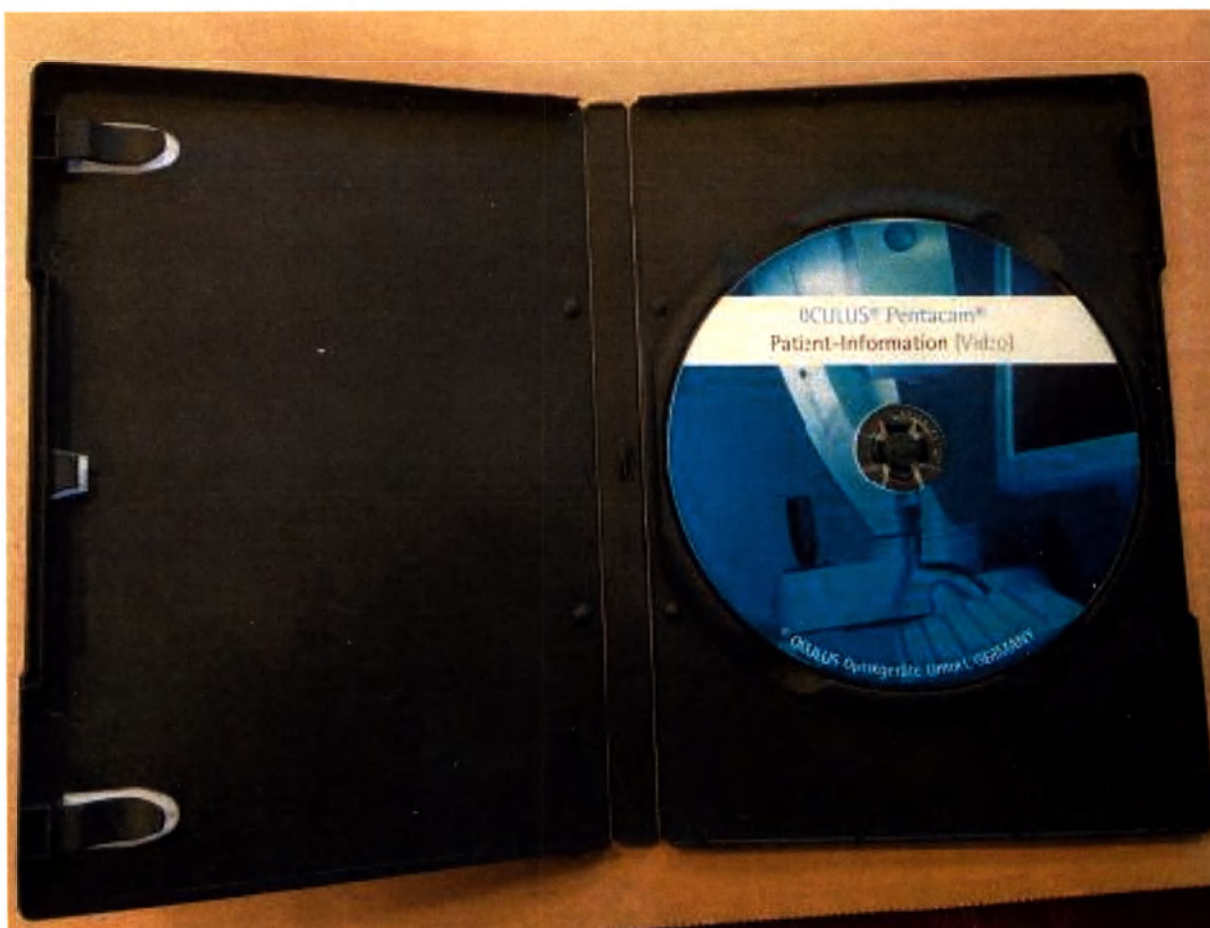


Рисунок 16 – Носитель с обучающим видео для пользователя.



Рисунок 17 – Крышка для рейки.



Рисунок 18 – Бумага для подбородника.



Рисунок 19 – Шильдик.

Анализатор переднего отрезка глаза с функцией оптической биометрии Pentacam AXL WAVE

Изготовитель: OCULUS Optikgeräte GmbH, Германия
Münchholzhäuser Str. 29, 35582 Wetzlar, Germany.

Страна происхождения: Германия

Уполномоченный представитель производителя в РФ :
ООО «РУМЭКС Медикал»
123592, г. Москва, ул. Кулакова д. 20 стр. 1Б, пом. IV, комн. 15-17, 33;
Тел: 8 (495) 966-09-15

Регистрационное удостоверение
№ XXX 202X/XXXXXX от XX XX 202X года.

Дата изготовления/Серийный номер/ – см. на упаковке.

Рисунок 20 – Маркировка транспортной упаковки.

Прошито, пронумеровано

22/двадцать два лист (а/ов)

Скреплено печатью.

