



Фотографические изображения

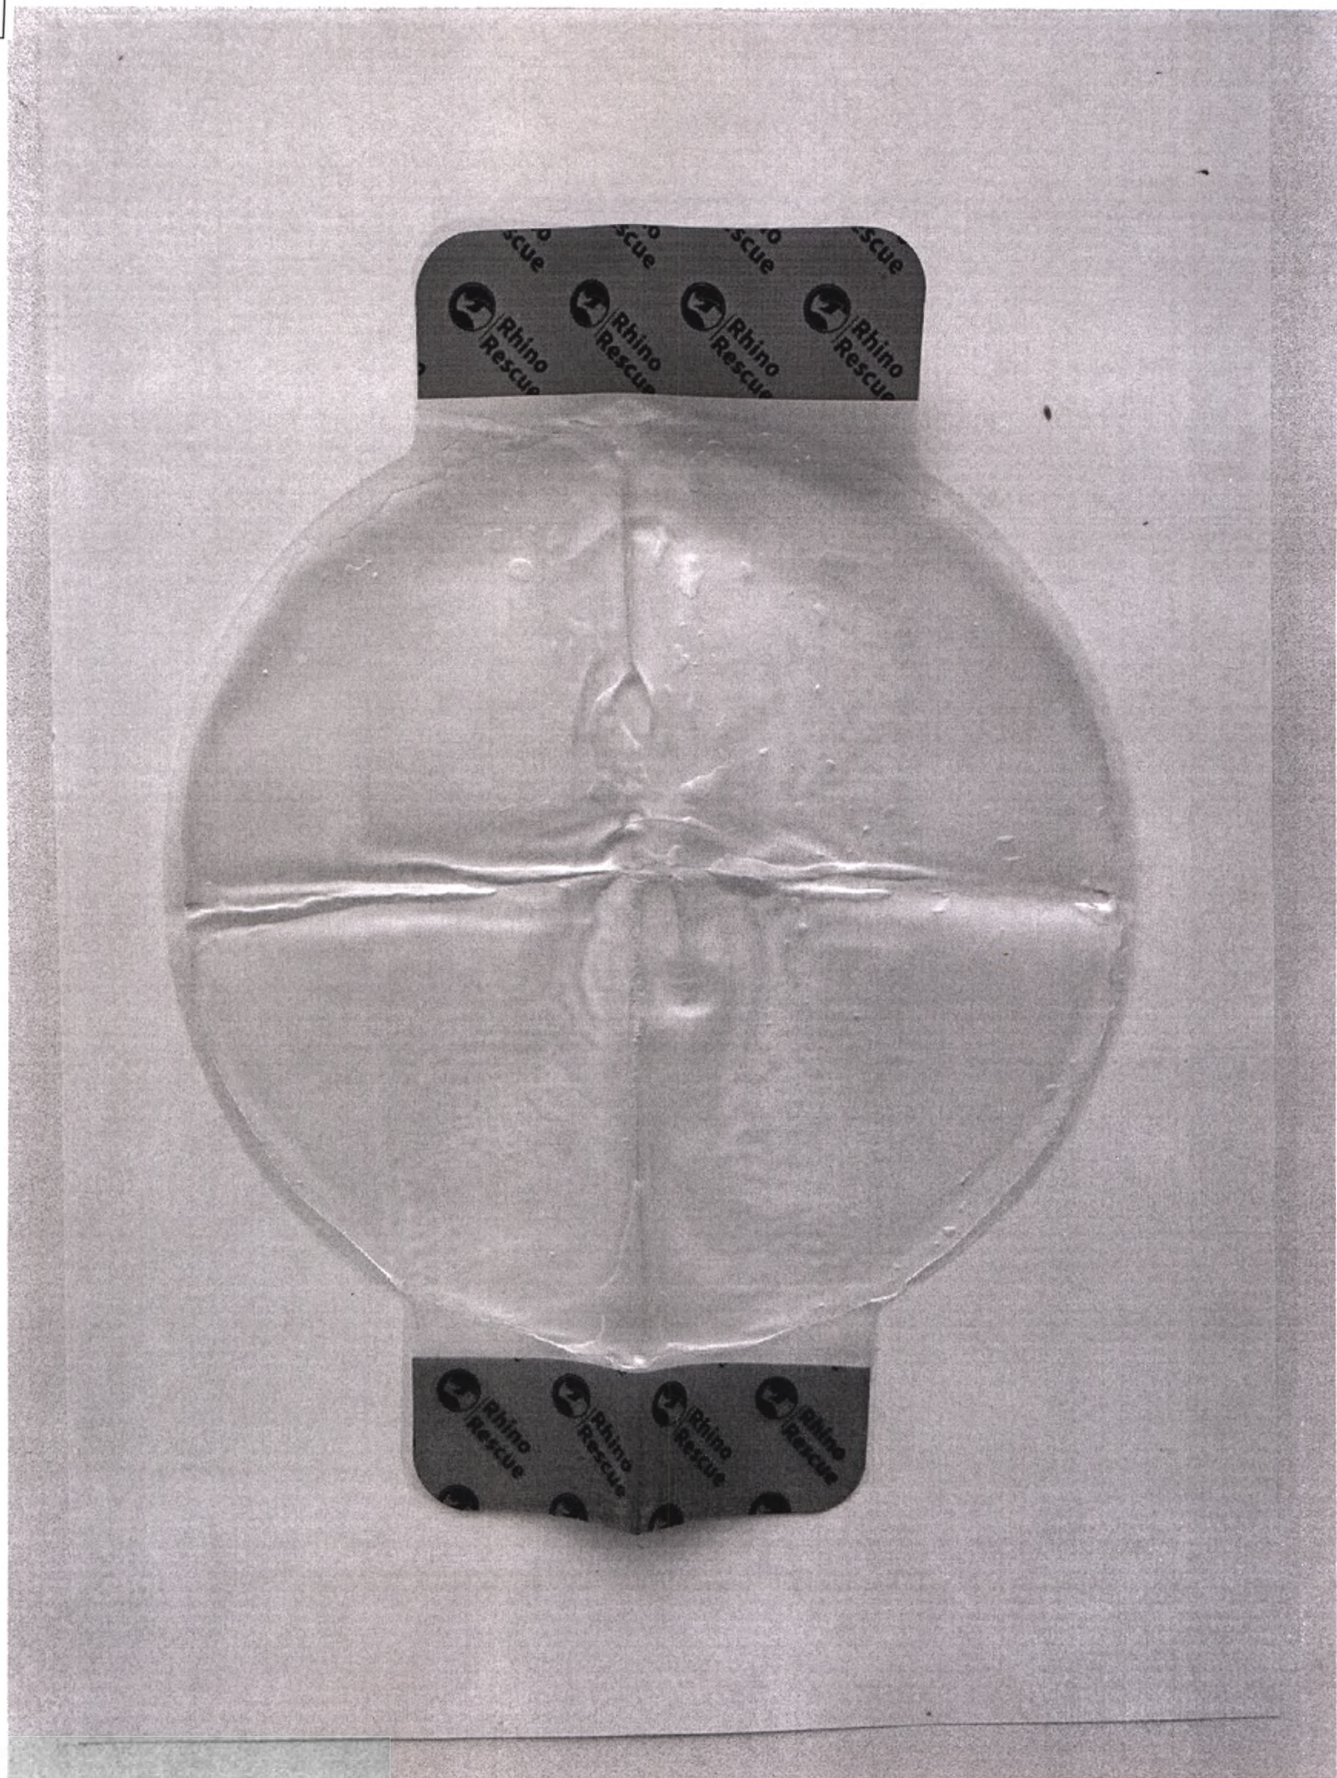


Окклюзионный пластырь одноразовый стерильный без вентиляции без упаковки

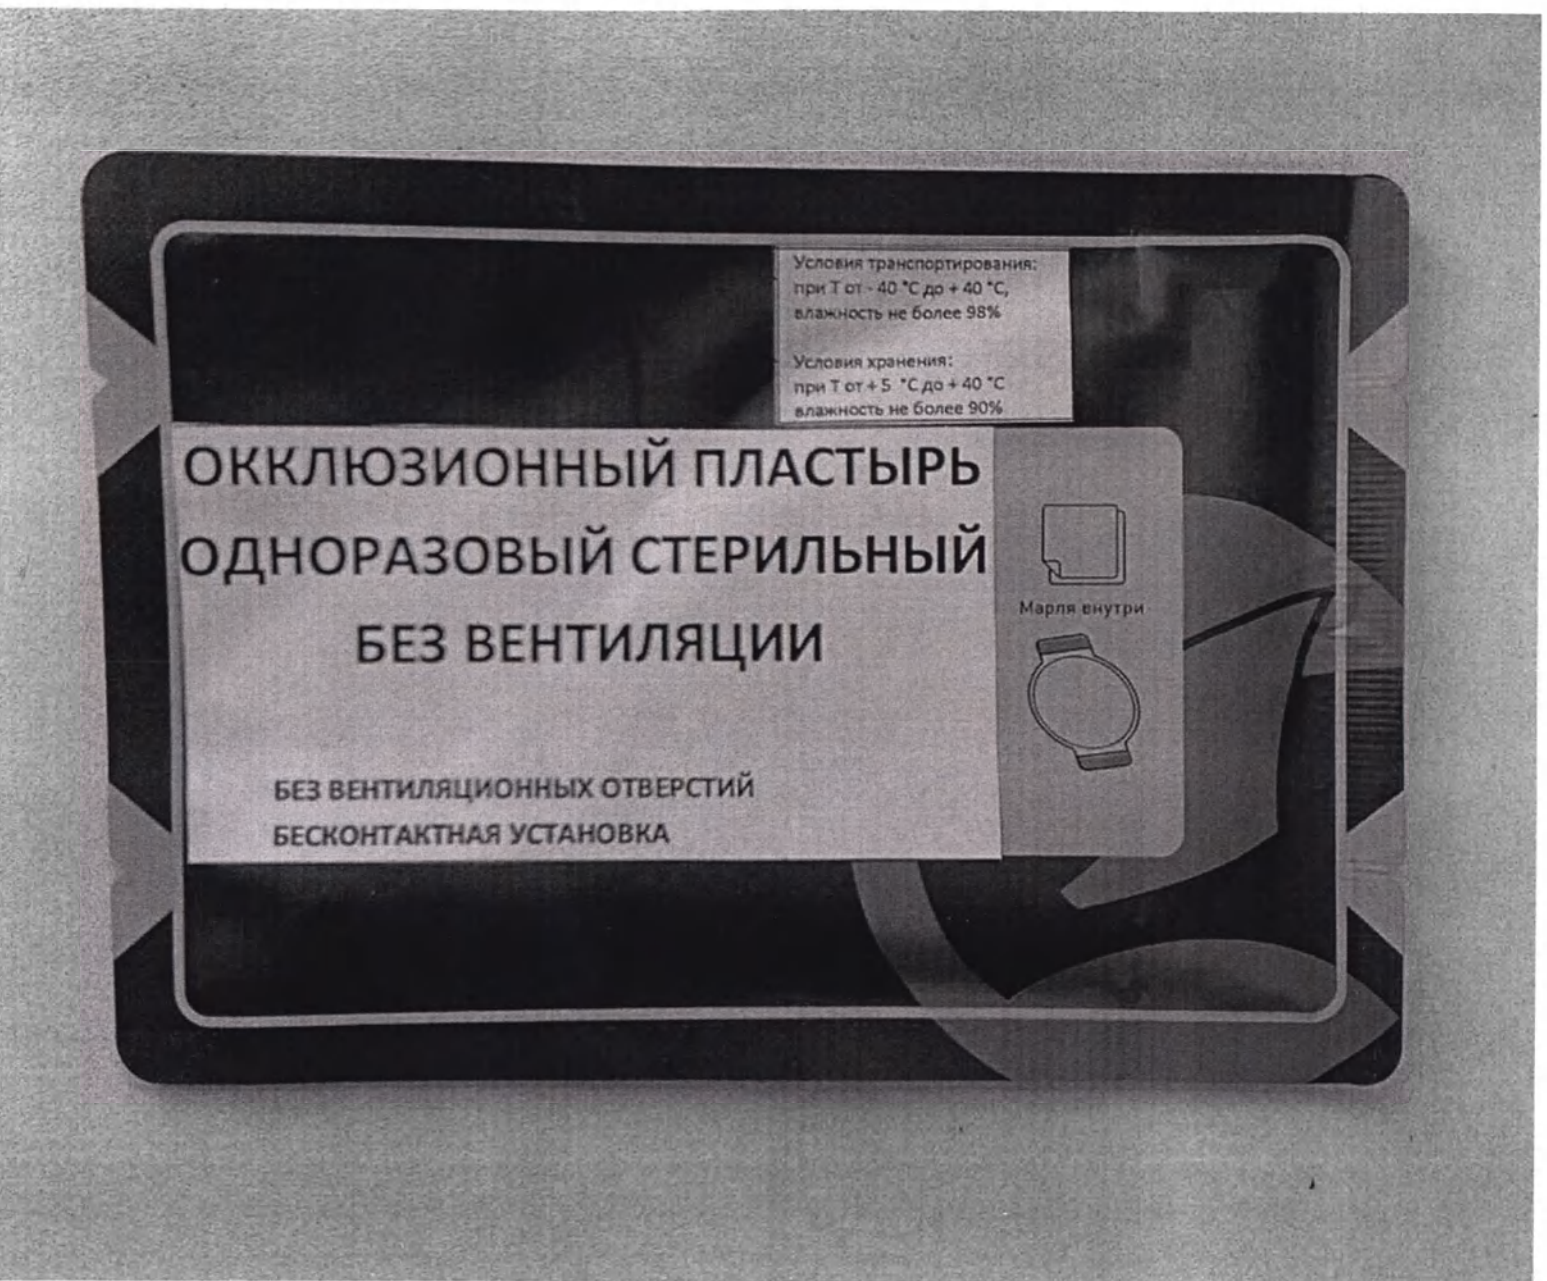


Образец маркировки с информацией на первичной упаковке изделия в варианте исполнения
Окклюзионный пластырь одноразовый стерильный без вентиляции



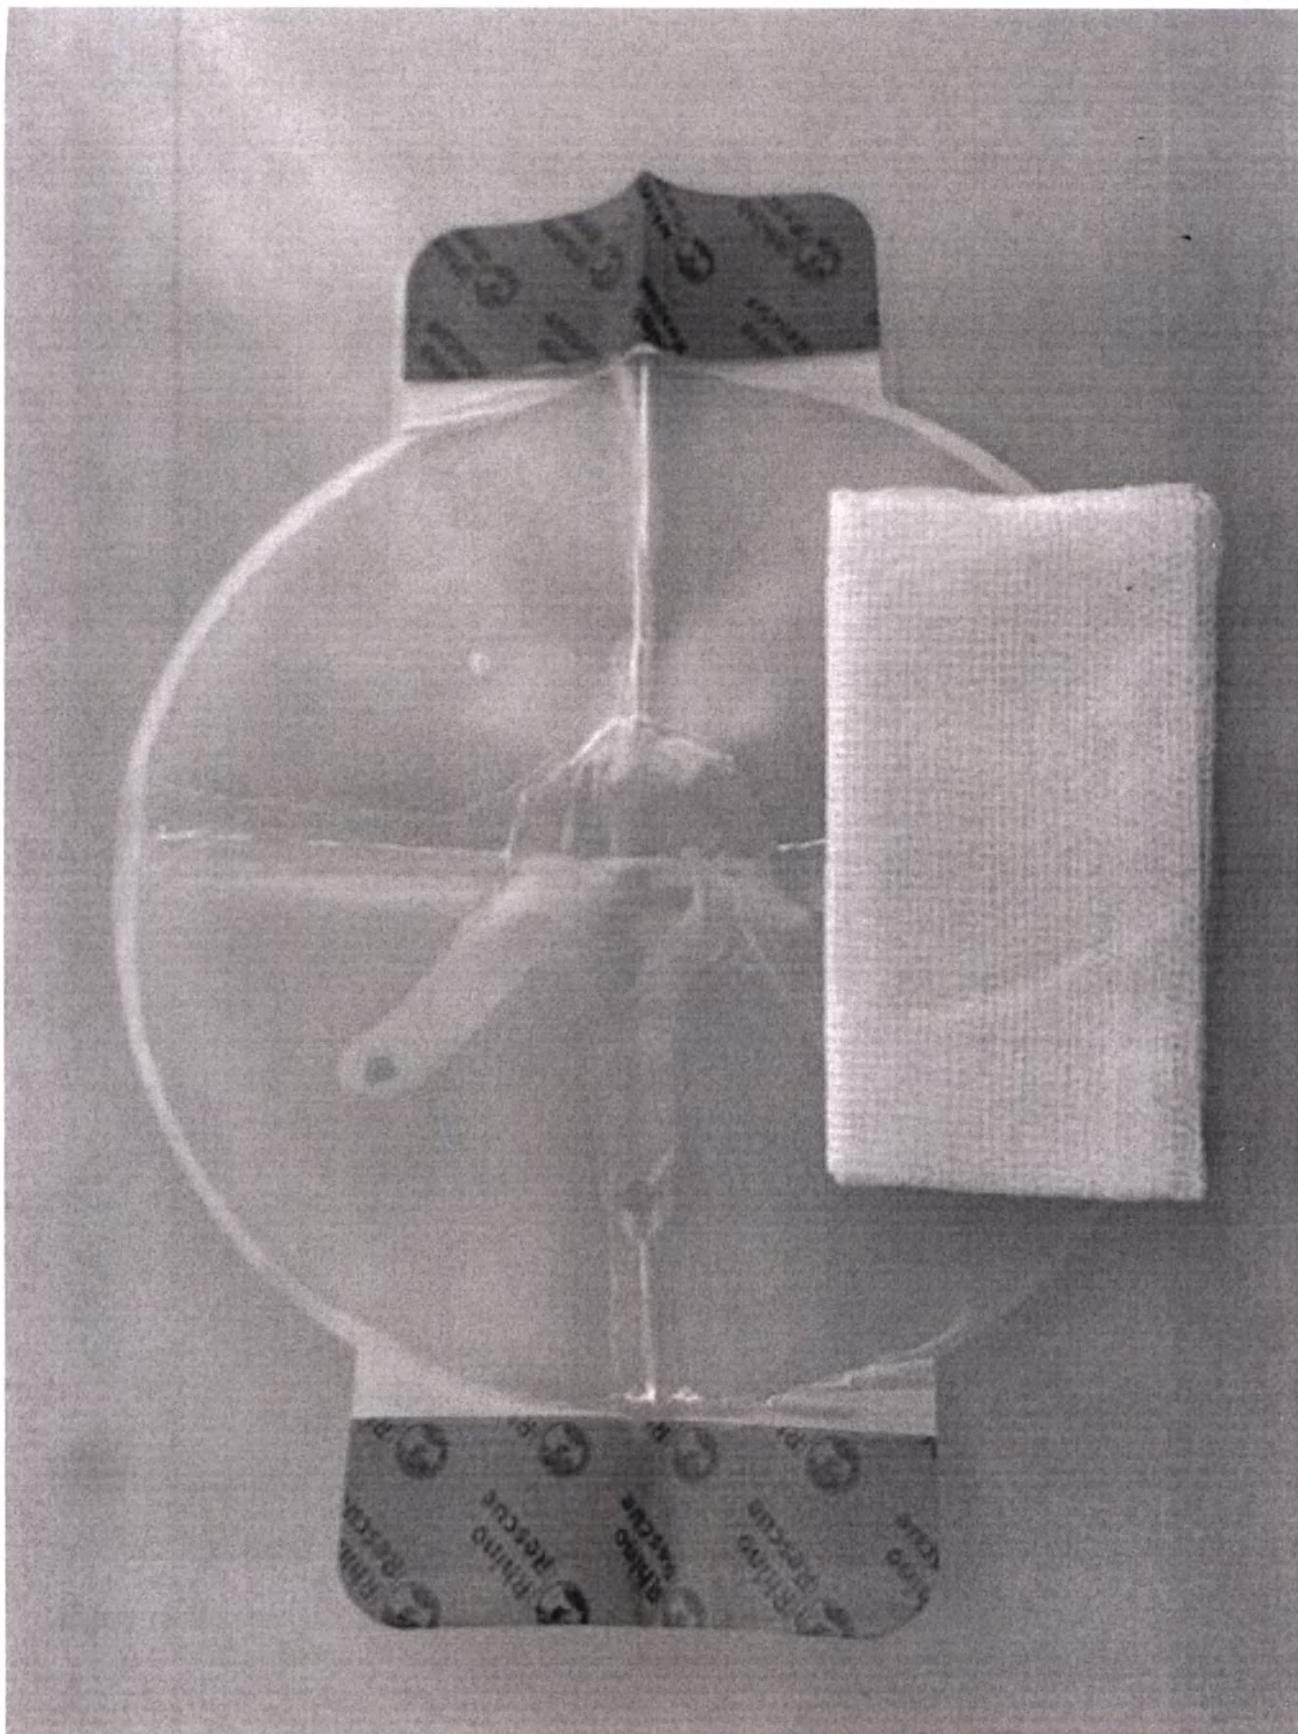

Окклюзионный пластырь одноразовый стерильный вентилируемый
без упаковки с входящей в комплект марлей

Образец маркировки с информацией на первичной упаковке изделия в варианте исполнения
Окклюзионный пластырь одноразовый стерильный вентилируемый

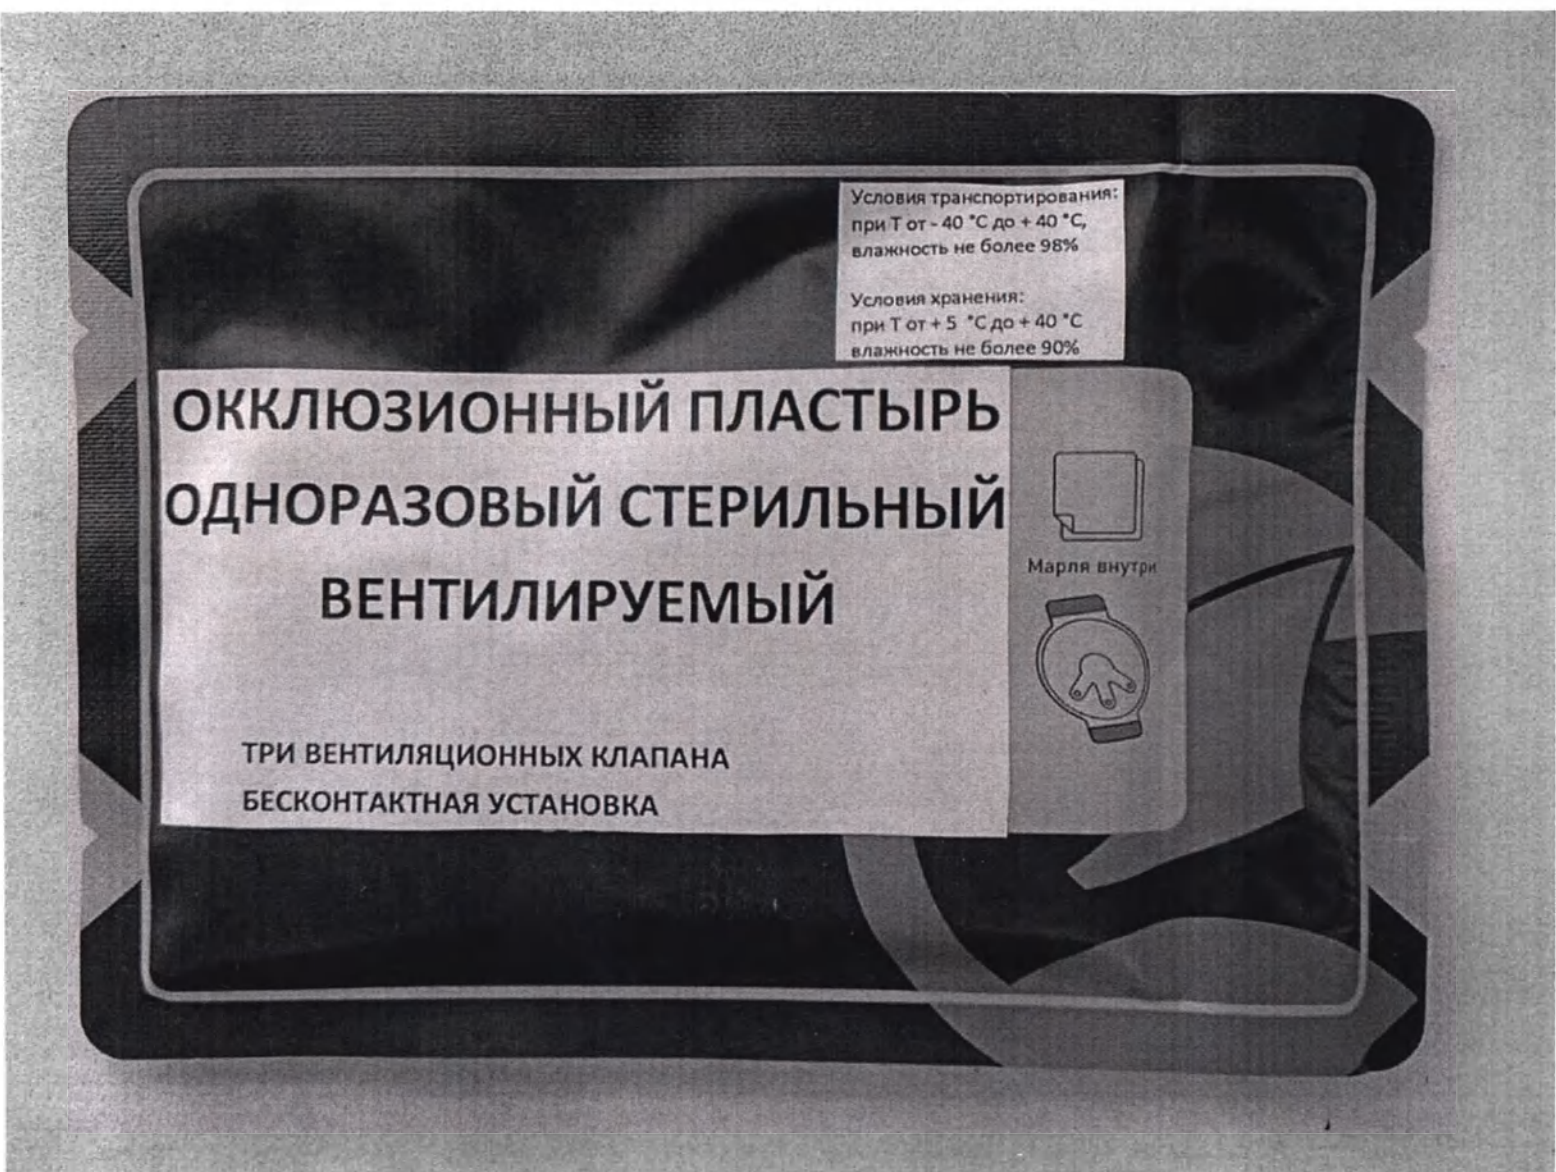

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1



Необходимо очистить и высушить поверхность возле раны марлей, которая идет в комплекте.

2



Снимите защитную пленку с клеевой поверхности.

3



Положите пластырь на рану пациента, клеевой стороной вниз.

4



Плотно прижмите пластырь к коже, чтобы обеспечить герметичность окклюзии.

LOT	20221230
	2022-12-30
EXP	2027-12-29

РУ № _____ от _____

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ХРАНИТЬ В ПРОХЛАДНОМ СУХОМ МЕСТЕ. ИЗБЕГАТЬ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ
- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ

WUXI EMSIJUN TECHNOLOGY CO., LTD
 9-201, Хуацзин Чуаньжи Парк,
 Зона экономического развития Хуэйшань,
 город Уси, провинция Цзянсу, Китай
 Уполномоченный в РФ: ООО «КАРТБЭЙ»
 107564, г. Москва, Погодный пр., д. 3, к.2, кв.21
 Тел.: +7-495-782-73-32
 e-mail: info@breadi.ru



STERILE R




ОККЛЮЗИОННЫЙ ПЛАСТЫРЬ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ



WUXI EMSRUN TECHNOLOGY CO., LTD


9-201, Хуацин Чуанчжи Парк, Зона экономического развития Хуэйшань,
город Уси, провинция Цзянсу, Китай

Дата упаковки: 10.04.2023

Уполномоченный в РФ: ООО «КАРТБЭЙ»
107564, г. Москва, Погонный пр., д. 3, к.2, кв.21
Тел.: +7-495-782-73-32
e-mail: info@breadi.ru

Условия транспортирования: при Т от - 40 °С до + 40 °С,
влажность не более 98%

Условия хранения: при Т от + 5 °С до + 40 °С,
влажность не более 90%



2023-04-10

Кол-во изделий: 50 шт.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 7 листа(ов)

Генеральный директор ООО «КАРТБЭЙ»

Н.А. Шилов

