


Фотографические изображения
медицинского изделия

Электрокардиограф МАС в вариантах исполнения, с принадлежностями

Производства

**GE Medical Systems Information Technologies, Inc.
(ДжиИ Медикал Системз Информейшн Технолоджиз, Инк.)**

**GE Medical Systems Information Technologies, Inc.
9900 Innovation Drive Wauwatosa, WI 53226, USA,
США**

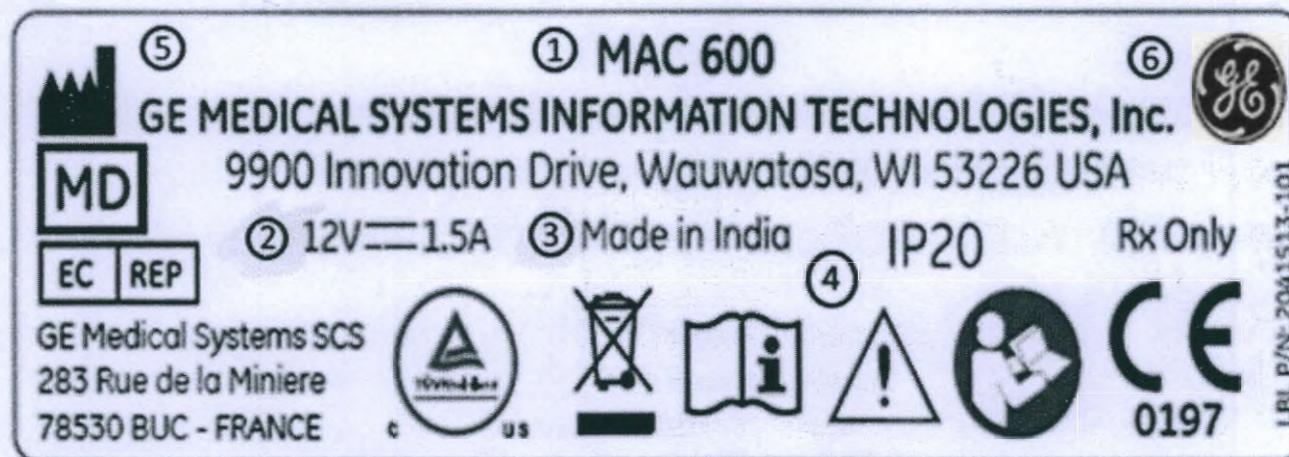

1	Наименование продукта (МАС 600)
2	Номинальное входное питание
3	Страна происхождения
4	Символы (Описание символов представлены в таблице ниже)
5	Наименование и адрес производителя
6	Логотип компании
Made in India	Сделано в Индии



GE Healthcare

Электрокардиограф MAC в вариантах исполнения

Электрокардиограф MAC 600

Руководство по эксплуатации

Версия программного обеспечения 1.02


2047626-006 Revision 2




MAC™ 600 Resting ECG Analysis System
Russian

© 2022 General Electric Company.
Все права защищены.


3. Блок питания.

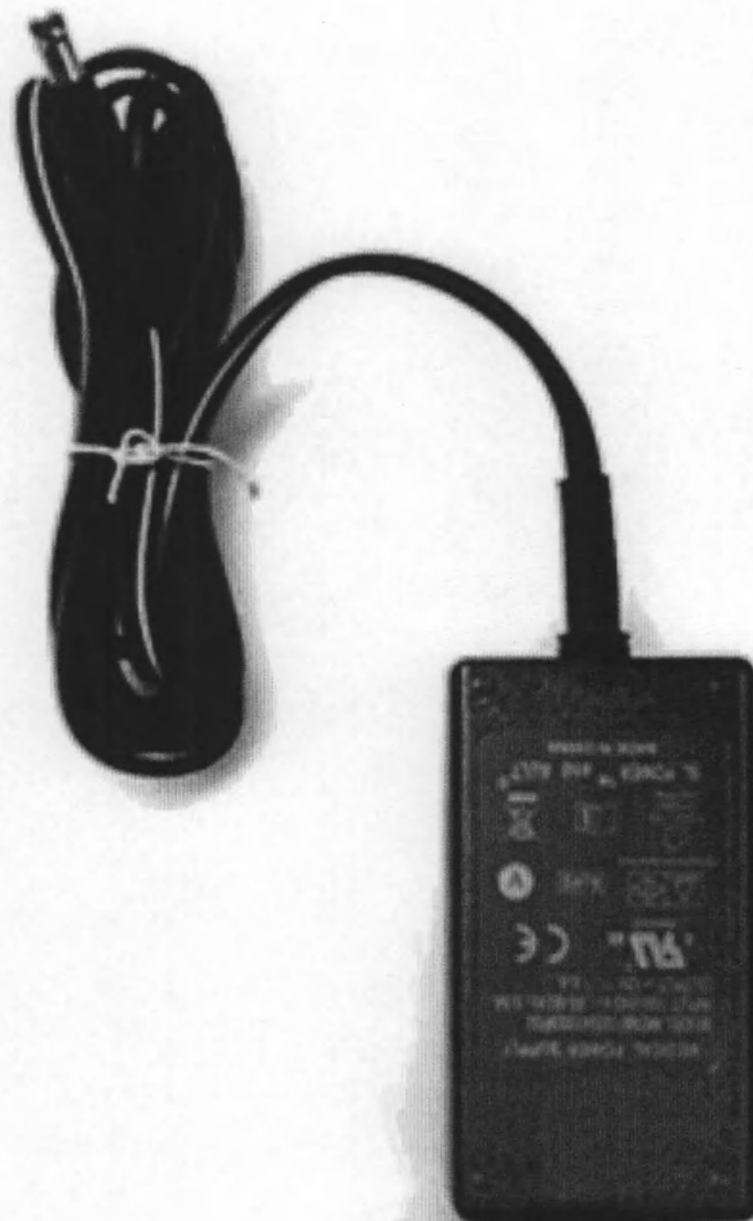


4. Спрей электродные во флаконе не менее 200 мл (не более 50 шт.), производитель GE Medical Systems Information Technologies, Inc., США (при необходимости).

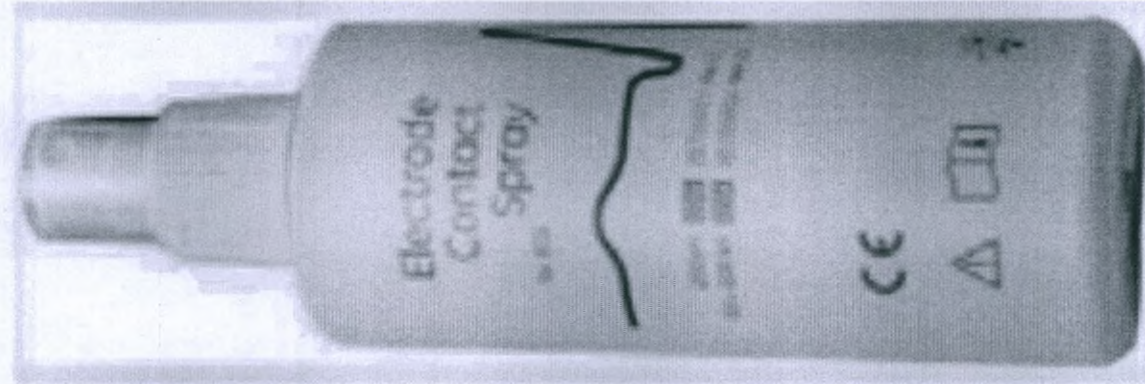


5. Спрей электродный контактный в канистре (не более 5 шт.). (при необходимости)

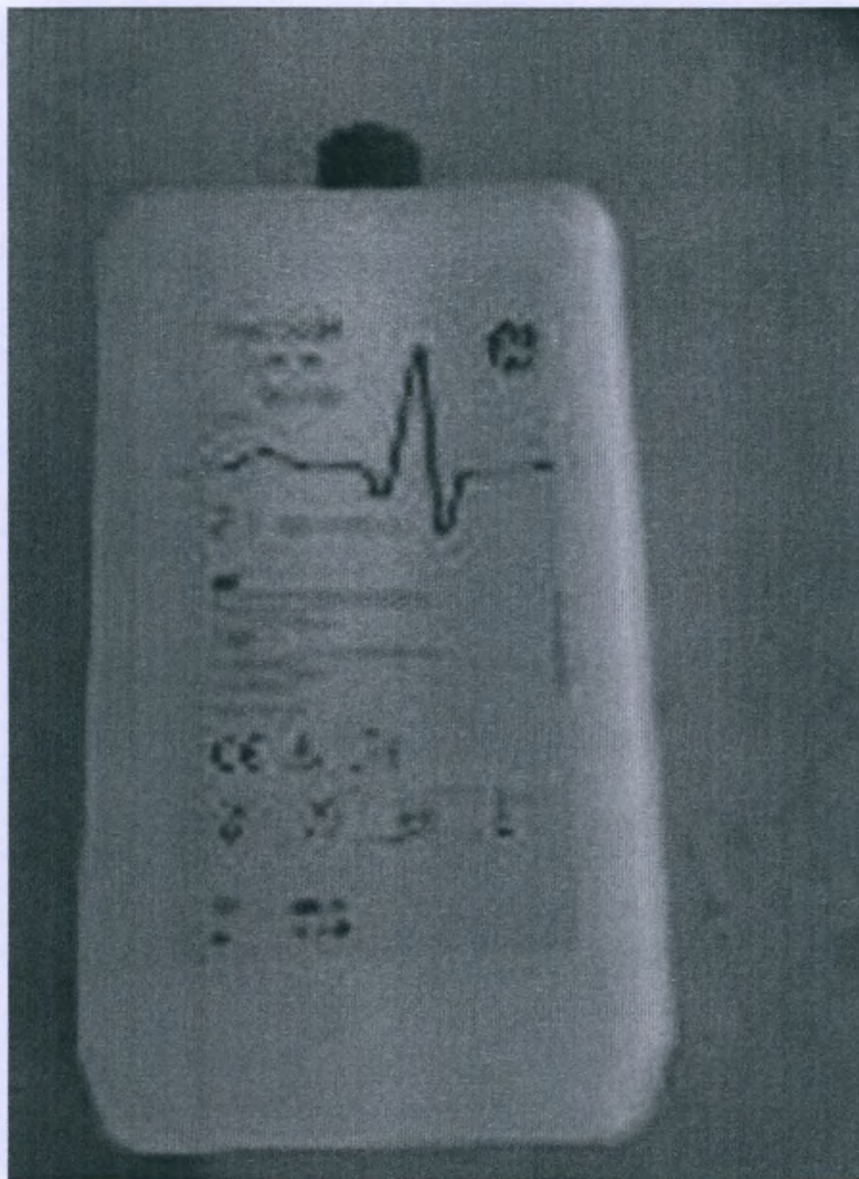


6. Кабели-электроды для наложения отведений при регистрации ЭКГ (не более 50 шт.) (при необходимости)

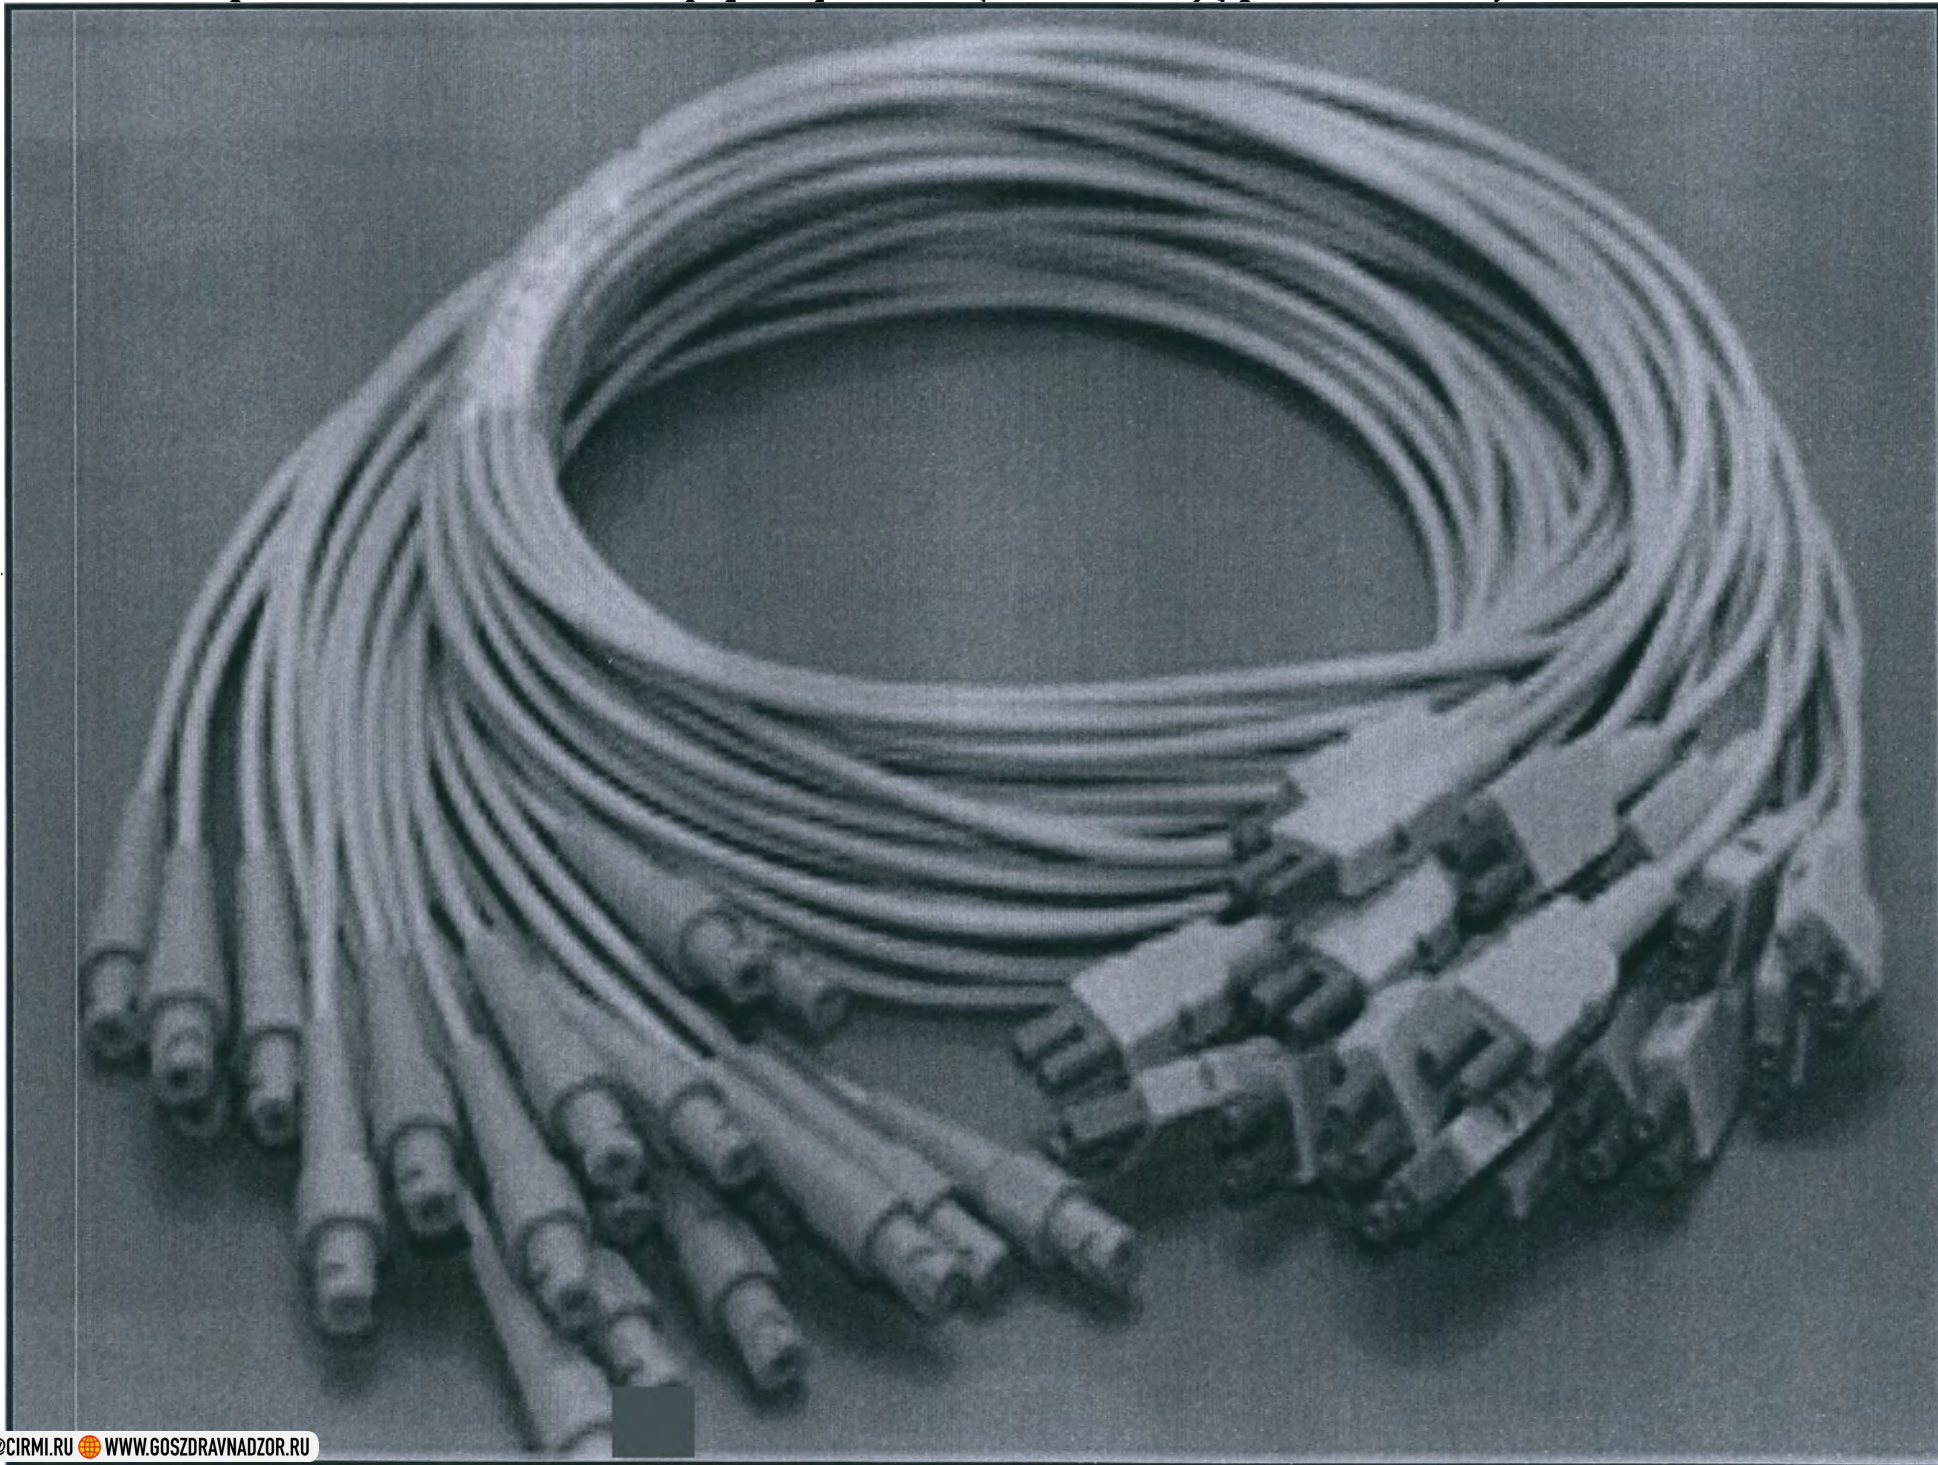


7. Кабели пациента интегрированные, ИЕС (не более 50 шт.). (при необходимости)

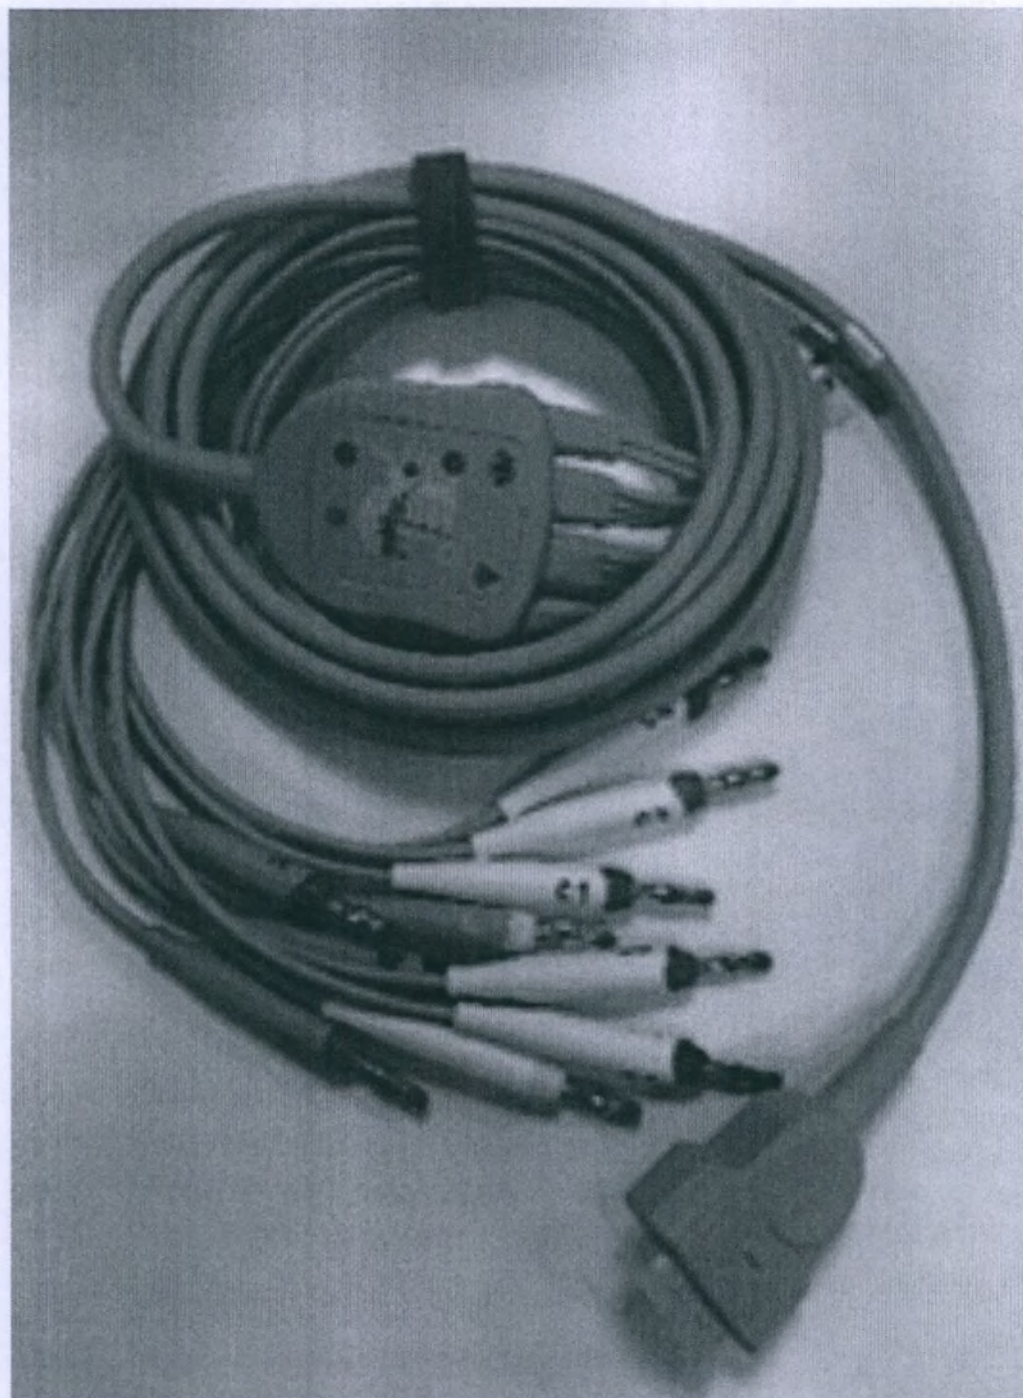


7. Кабели пациента интегрированные, ИЕС (не более 50 шт.). (при необходимости)

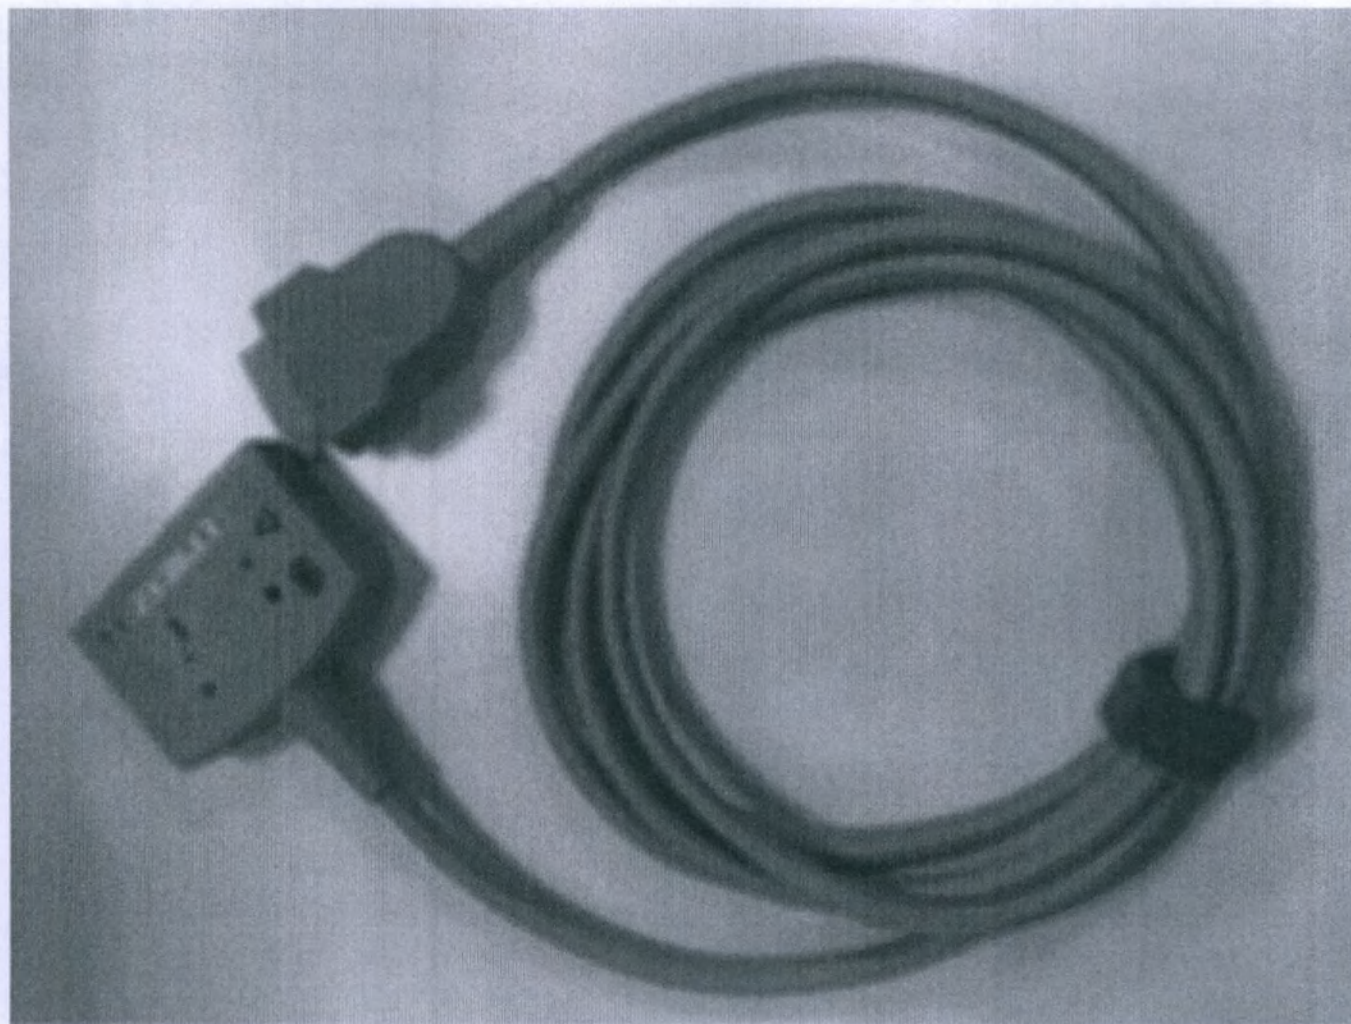


8. Кабели пациента интегрированные, АНА (не более 50 шт.). (при необходимости)

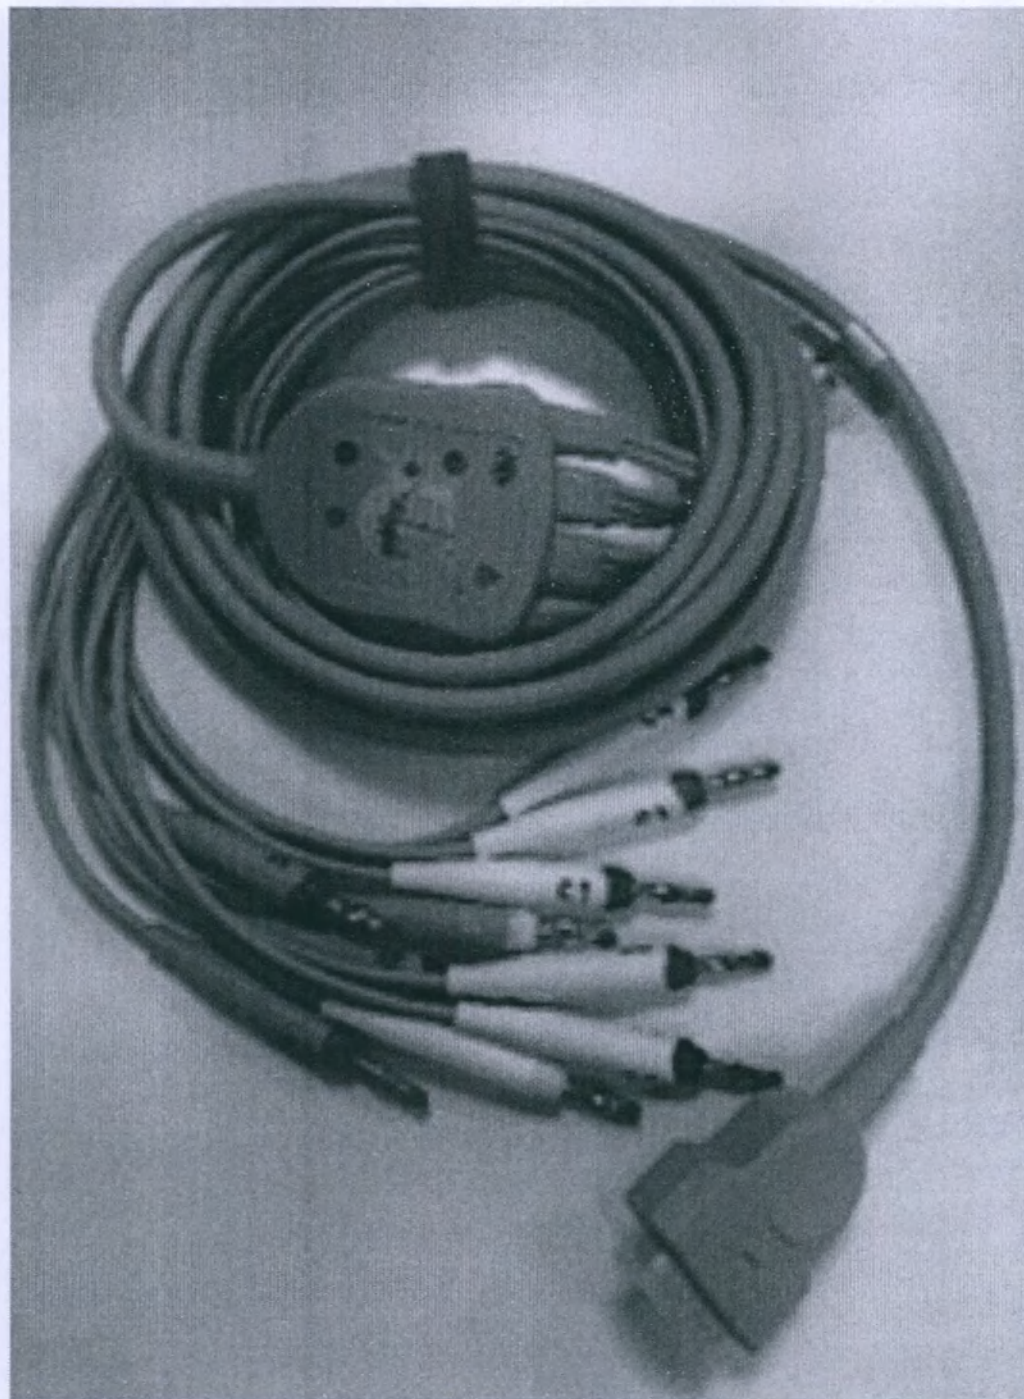


8. Кабели пациента интегрированные, АНА (не более 50 шт.). (при необходимости)

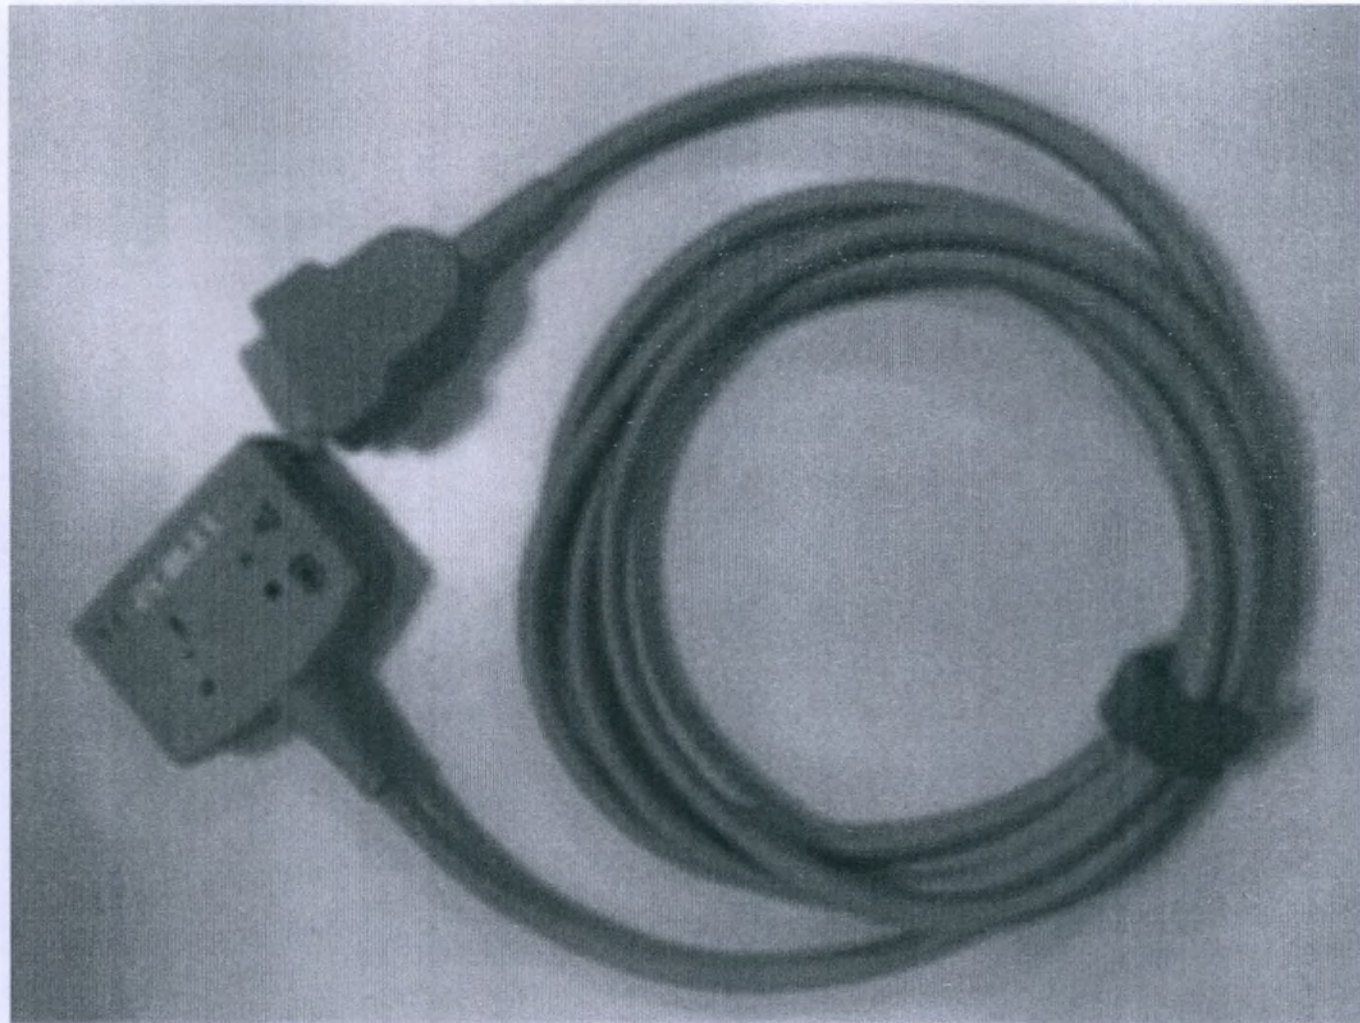


9. Кабели пациента магистральные АНА (не более 50 шт.). (при необходимости)

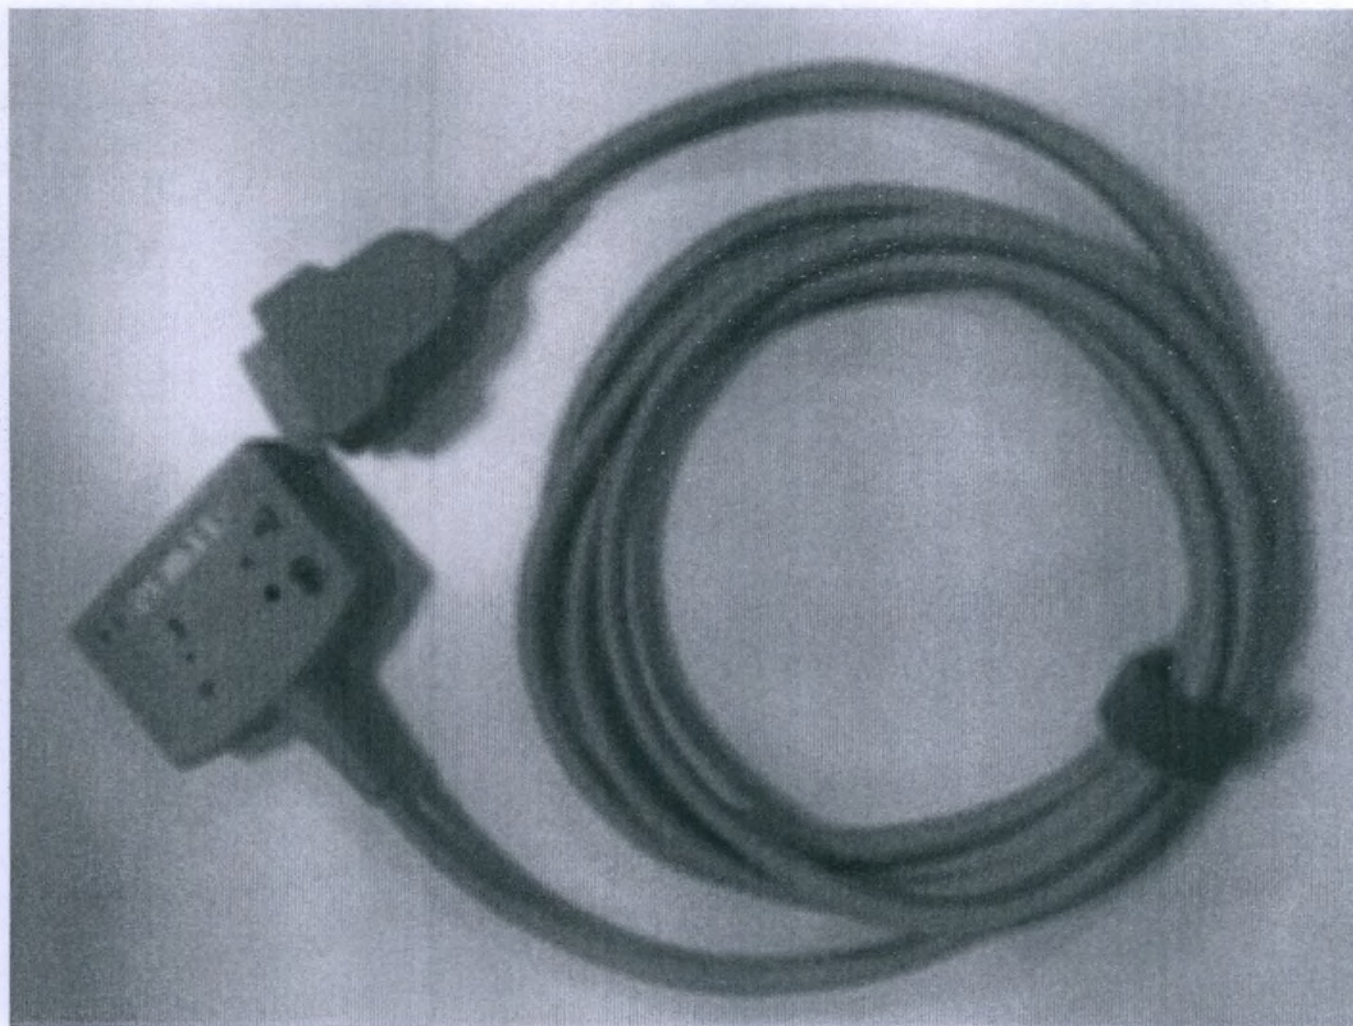


10. Кабели пациента магистральные IEC (не более 50 шт.). (при необходимости)

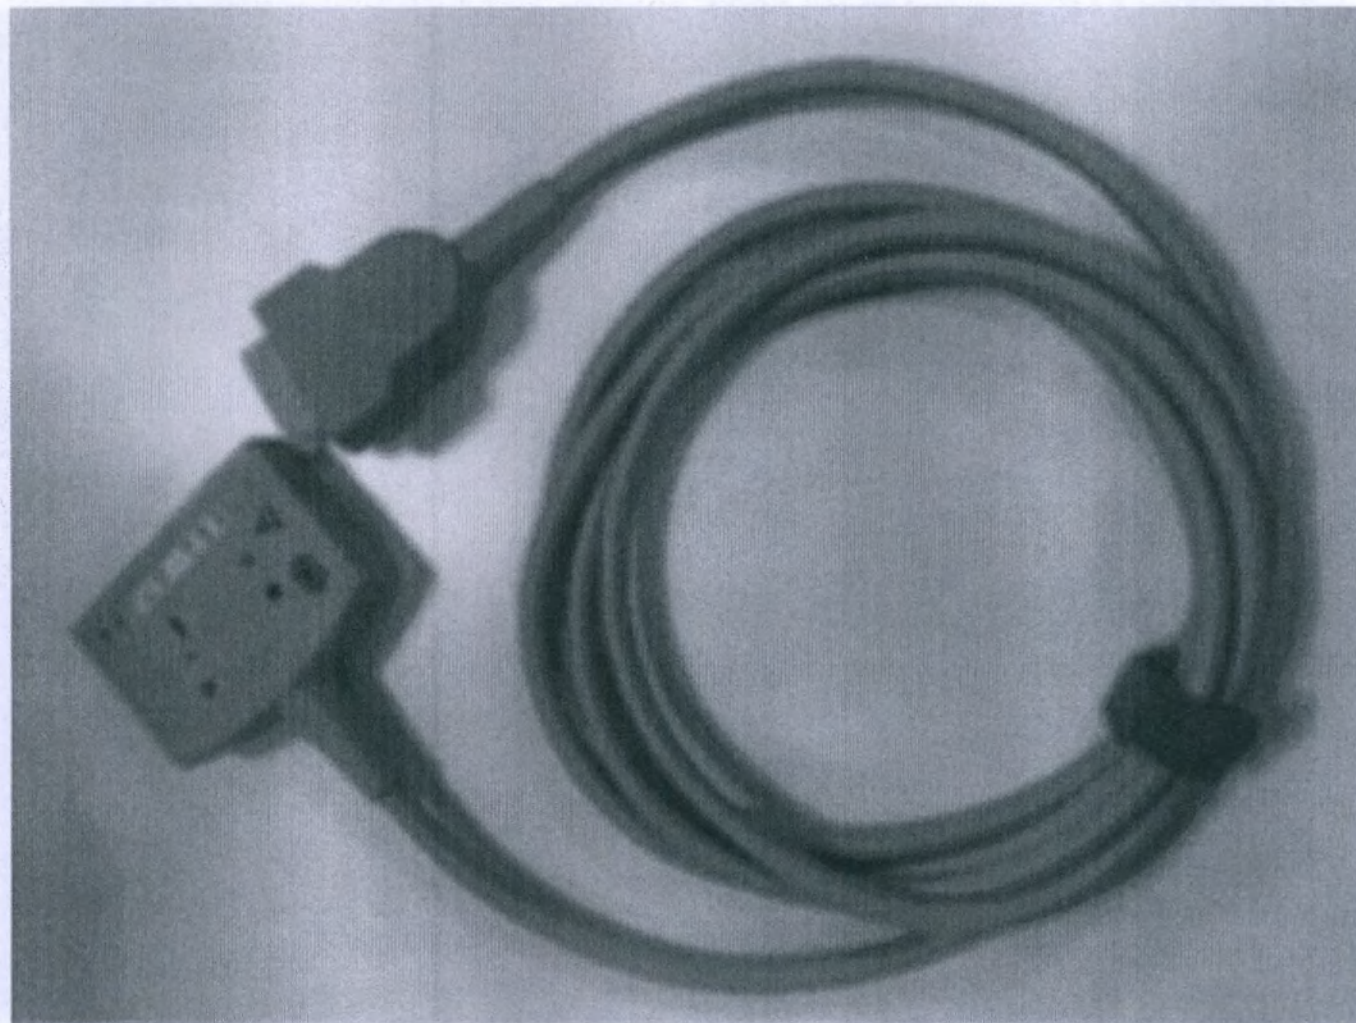


11. Адаптеры для многоцветных электродов типа Банан (не более 50 шт.). (при необходимости)

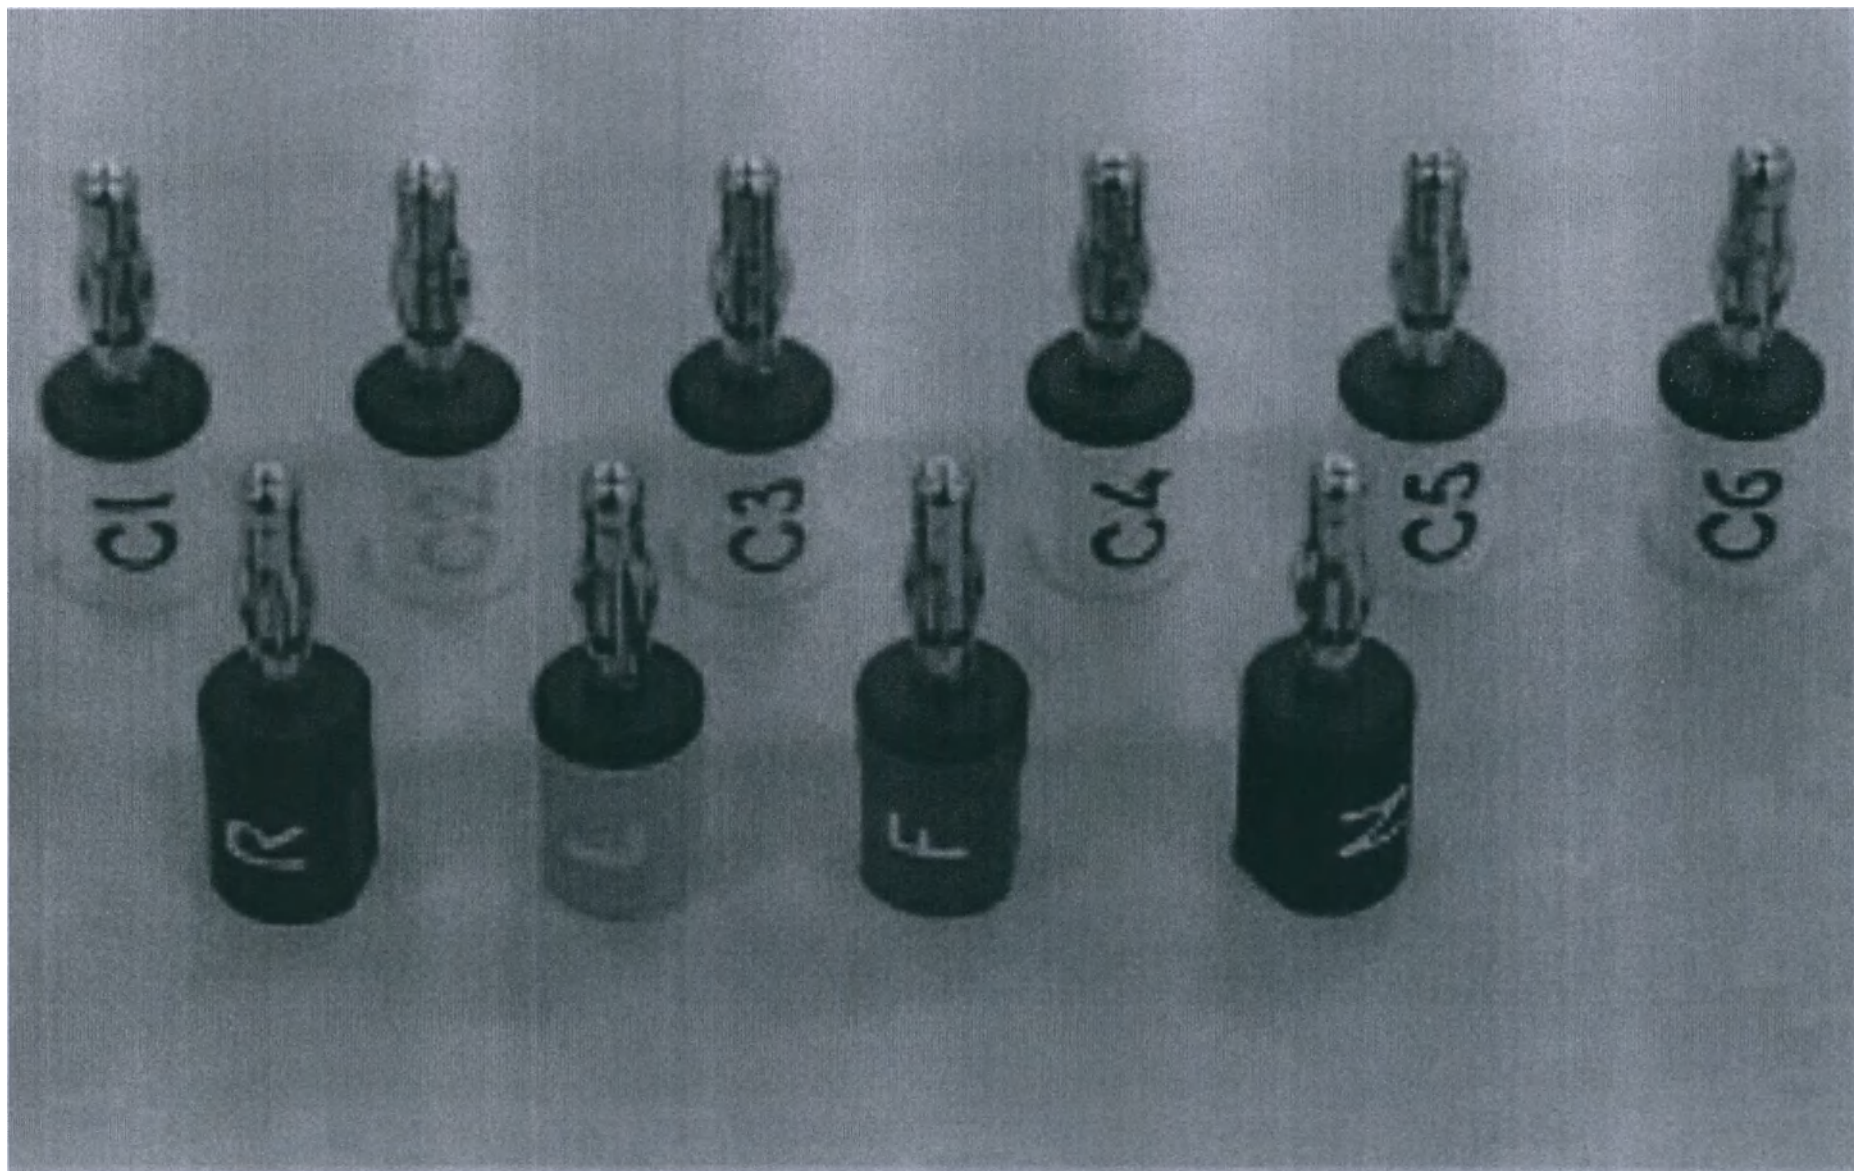


11. Адаптеры для многоэлектродов типа Банан (не более 50 шт.). (при необходимости)

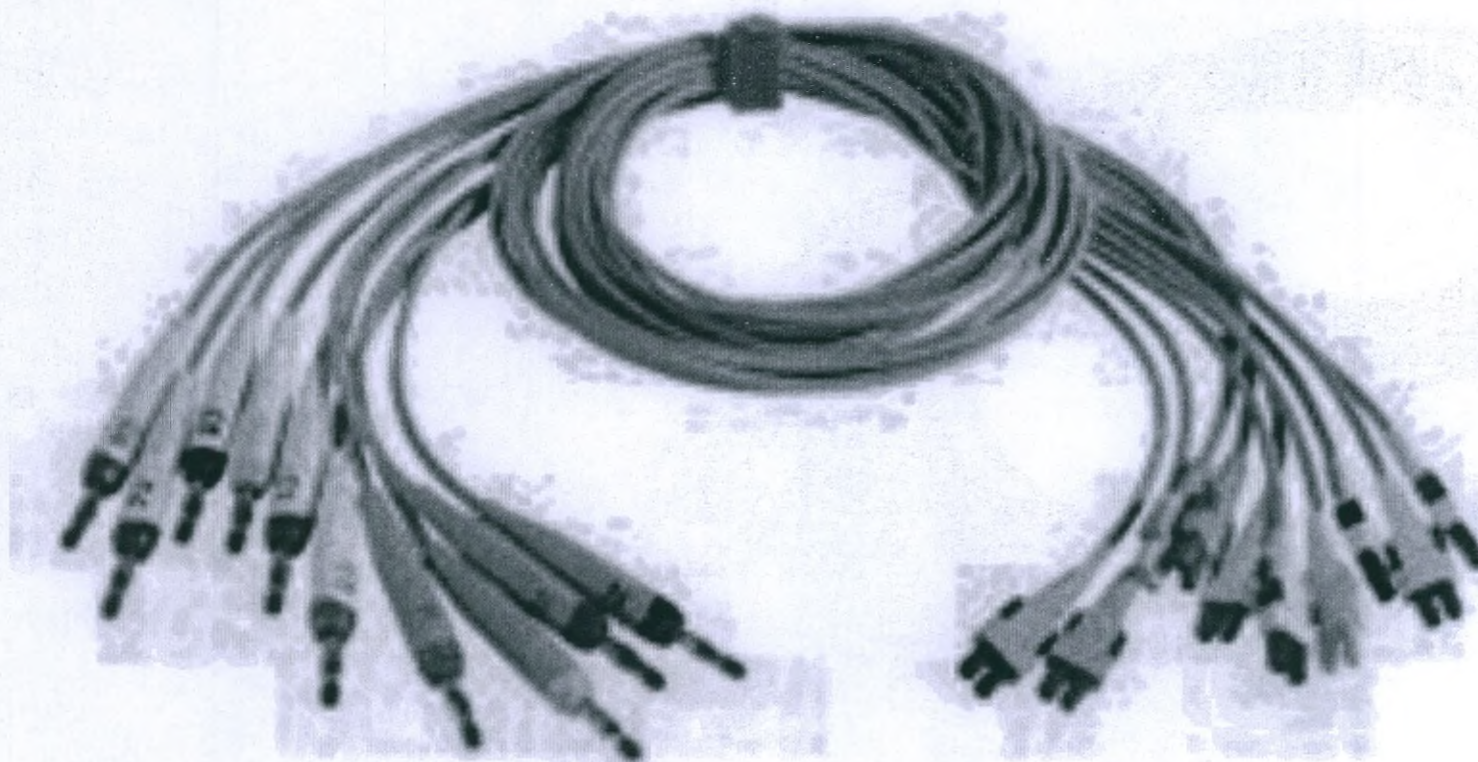


12. Адаптеры для многоэлектродов типа Граббер (не более 50 шт.) (при необходимости).

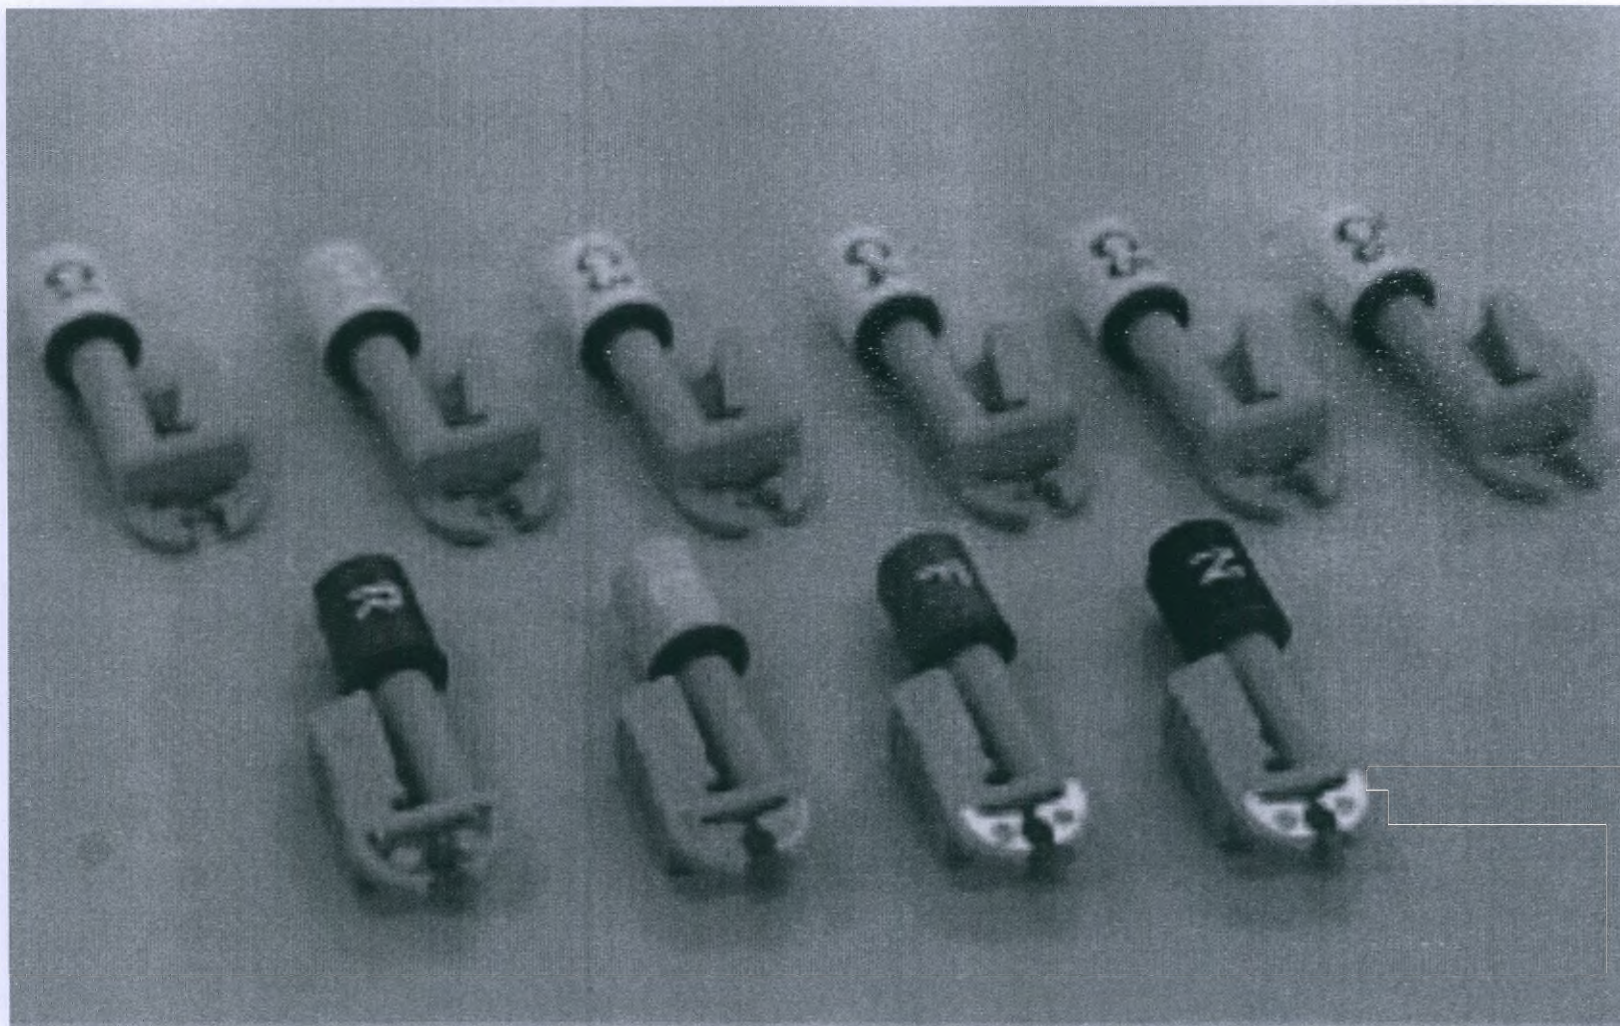


12. Адаптеры для многоэлектродов типа Граббер (не более 50 шт.) (при необходимости).

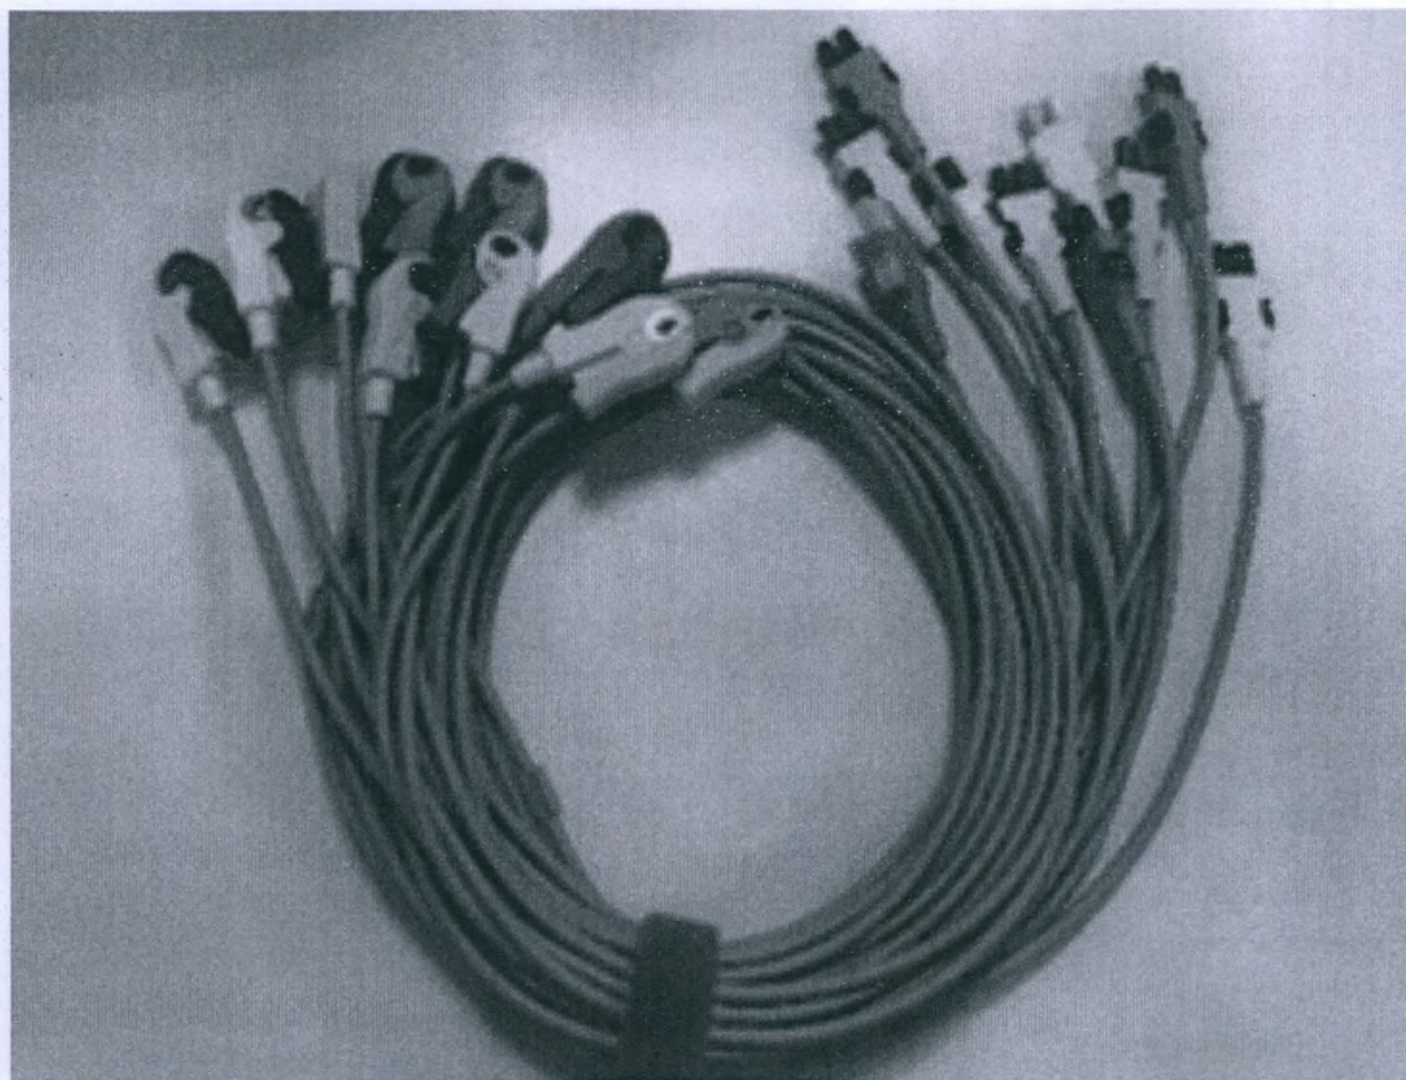


13. Набор отведений типа «граббер», 10 шт. в наборе, АНА (не более 50 шт.). (при необходимости)

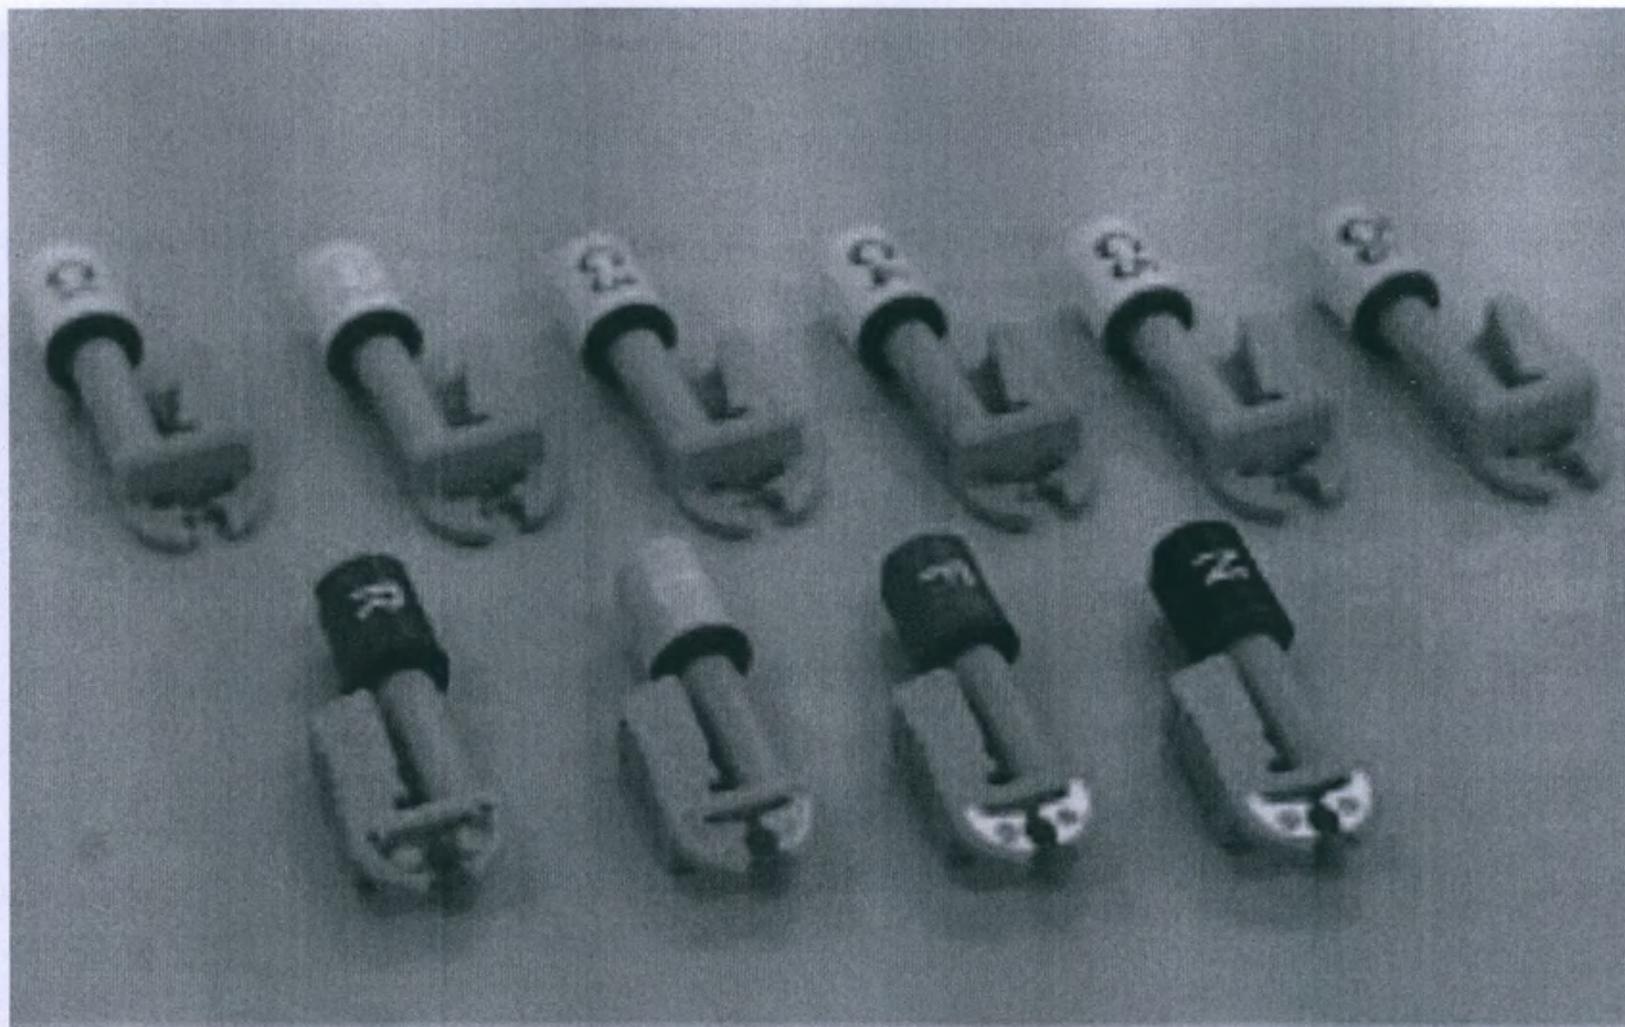


13. Набор отведений типа «граббер», 10 шт. в наборе, АНА (не более 50 шт.). (при необходимости)

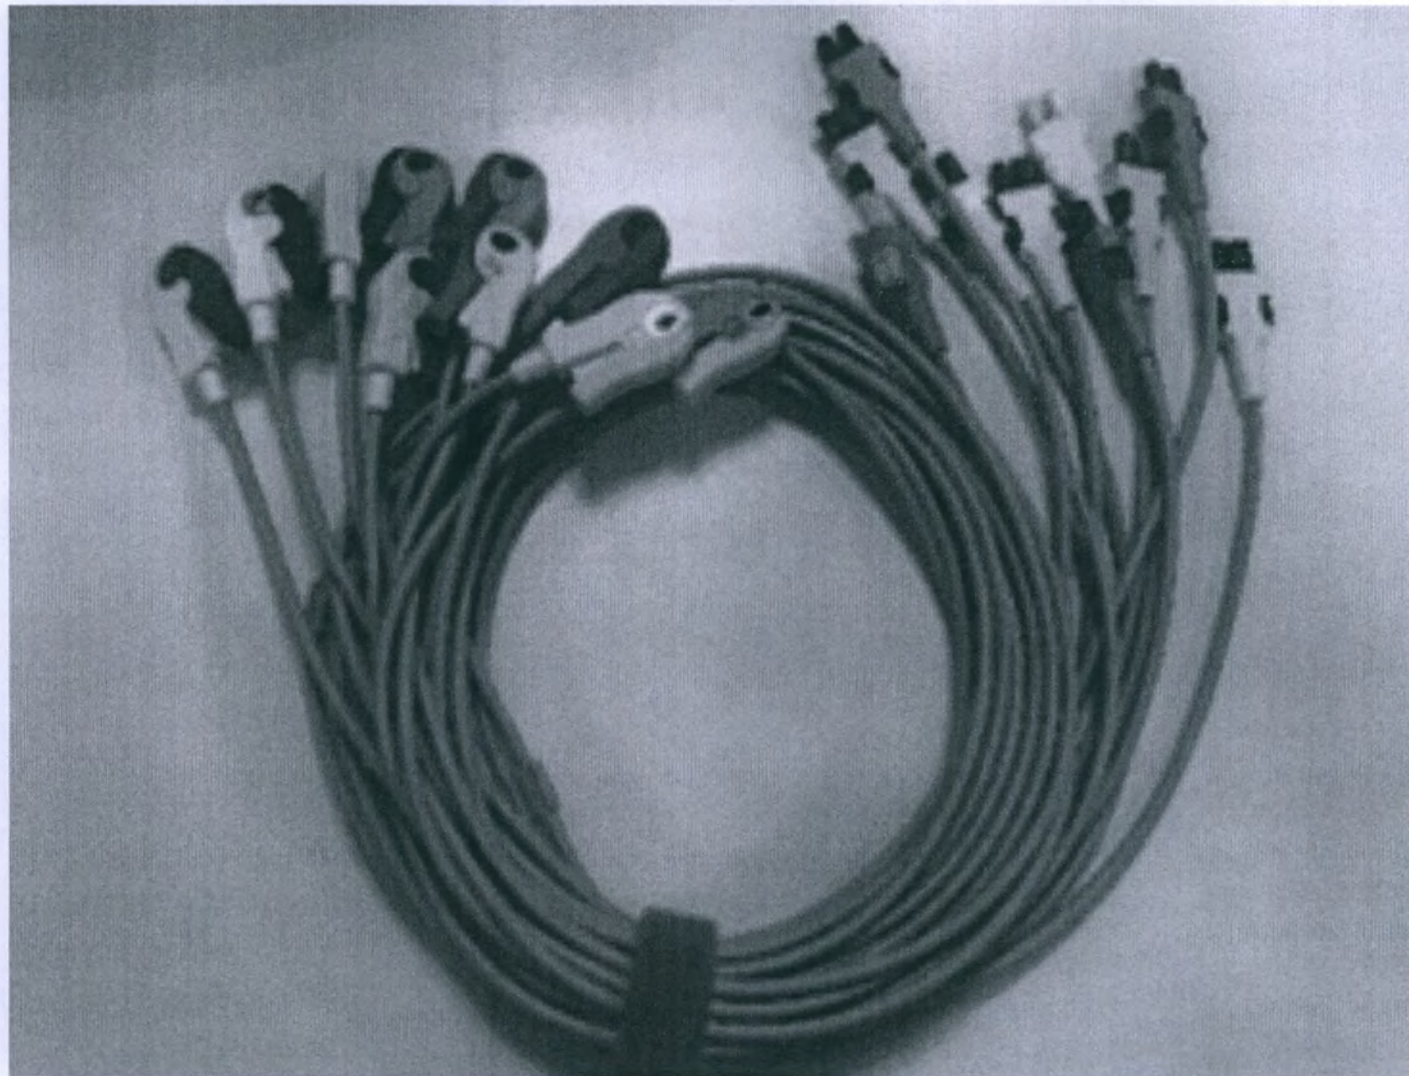


14. Переходники для ЭКГ (не более 10 упаковок) (при необходимости).

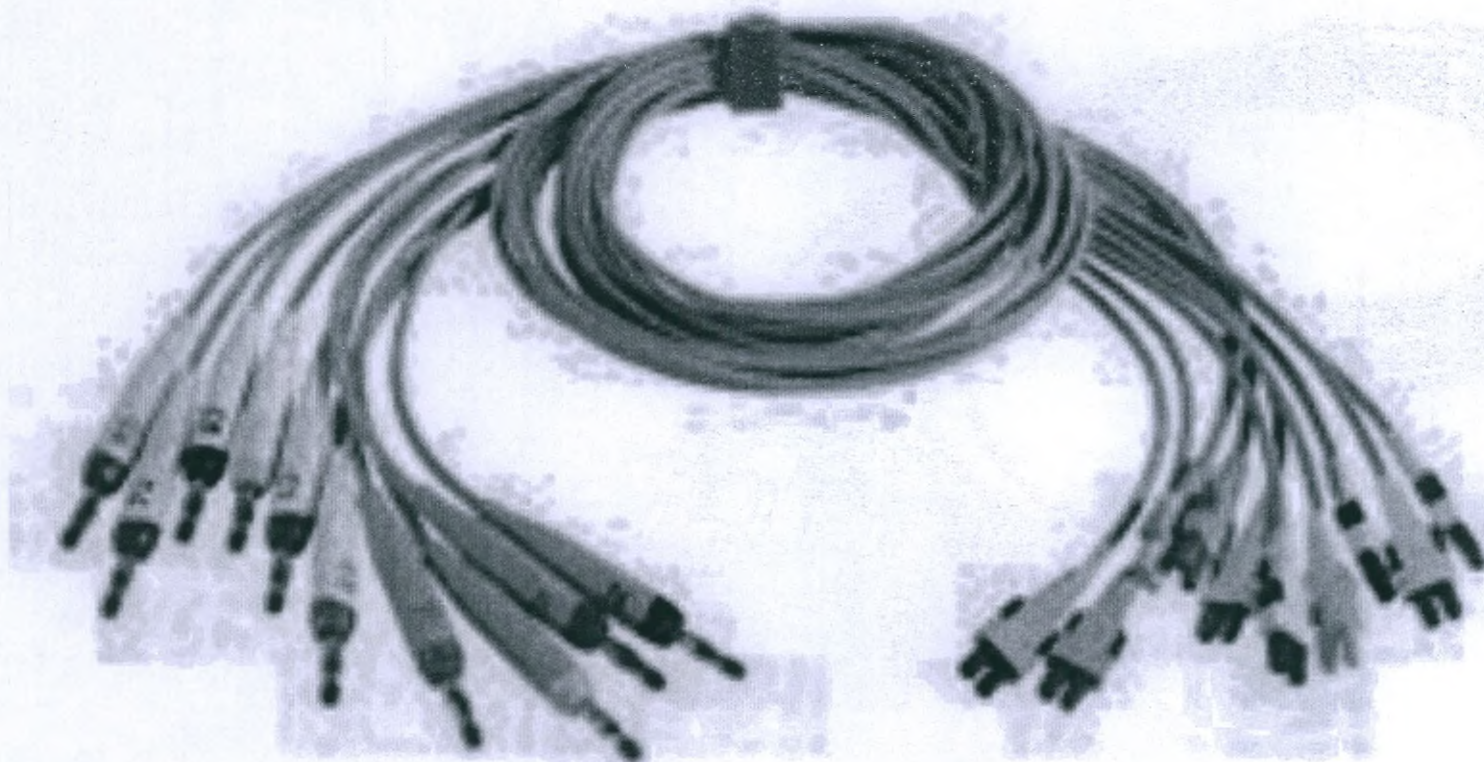


15. Набор дополнительных разъемов для ЭКГ типа банан, ИЕС, 4 шт. в упаковке (не более 10 упаковок) (при необходимости).

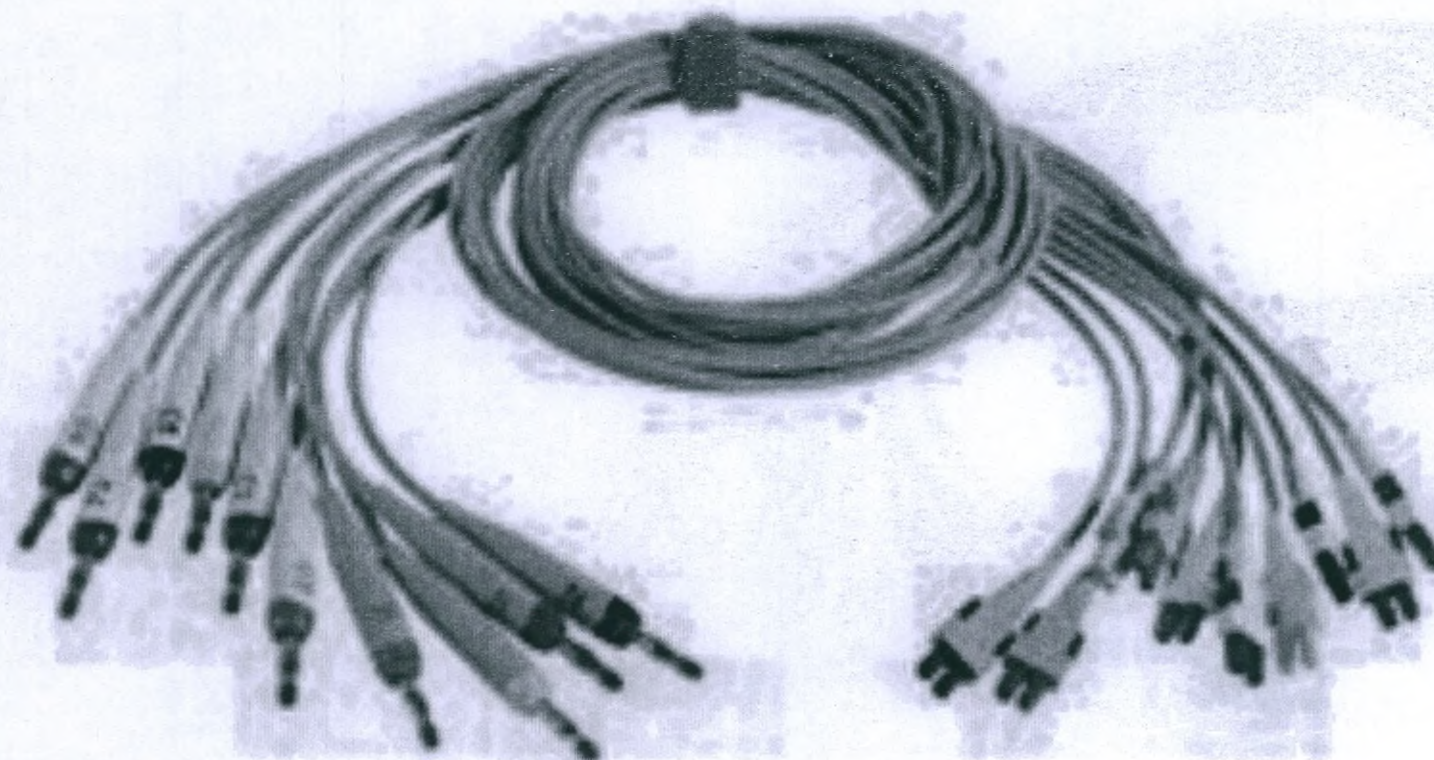


16. Разъем для ЭКГ (не более 10 упаковок) (при необходимости).

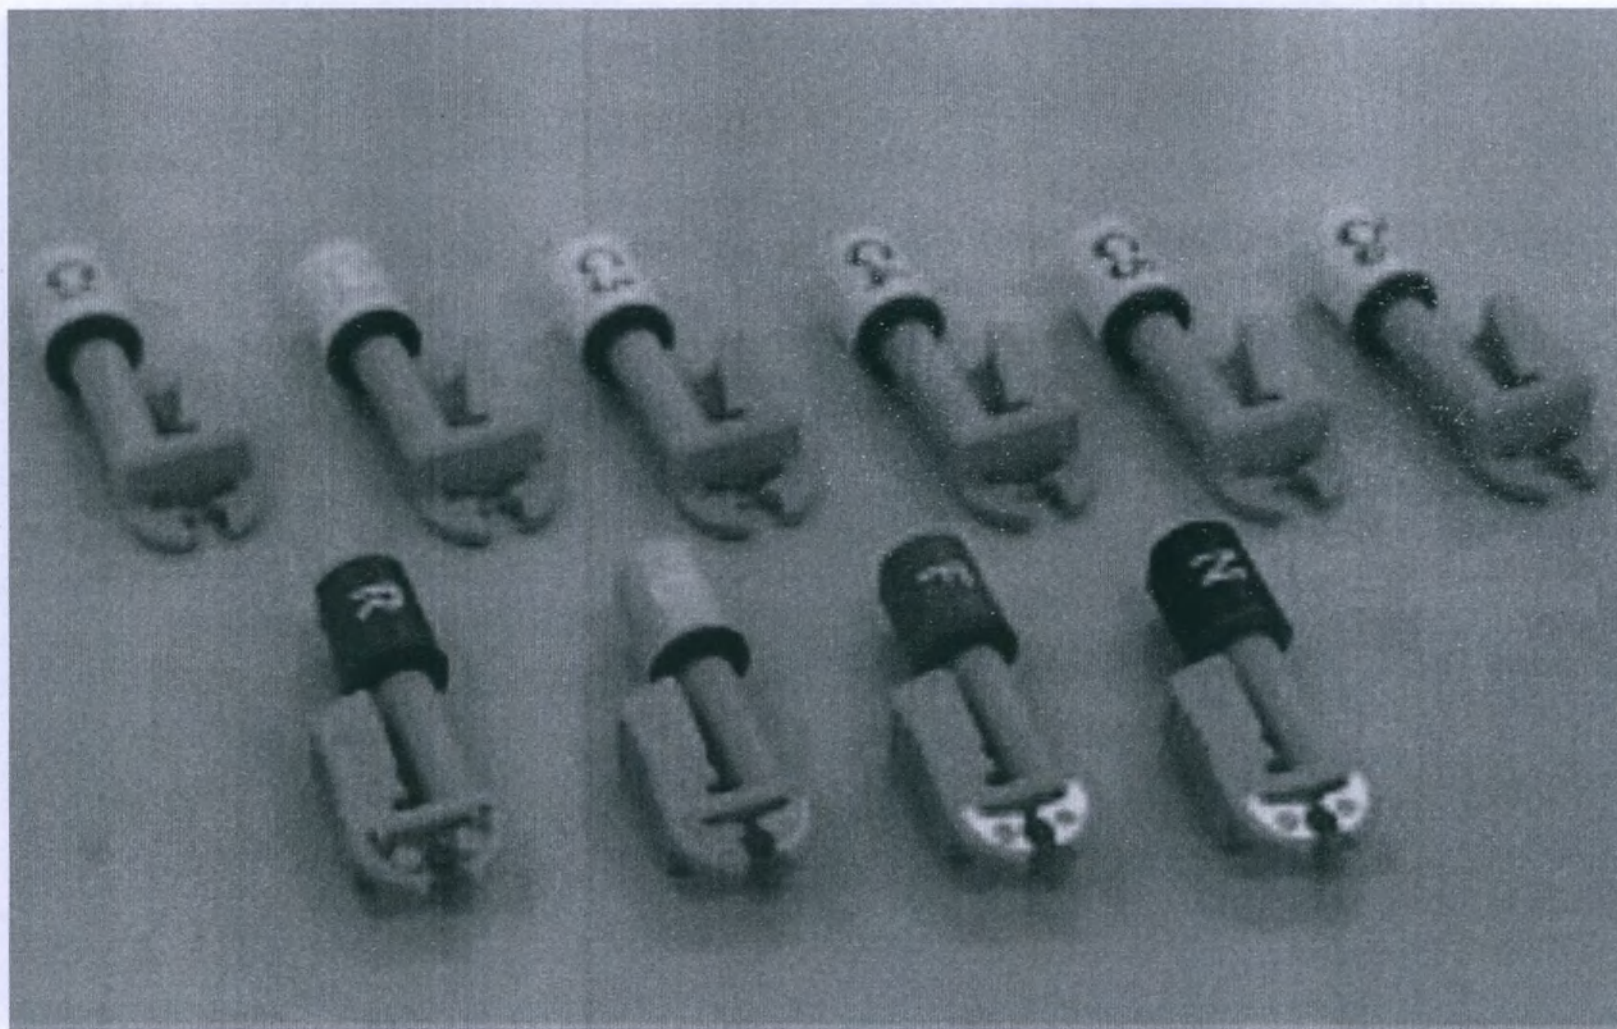


16. Разъем для ЭКГ (не более 10 упаковок) (при необходимости).

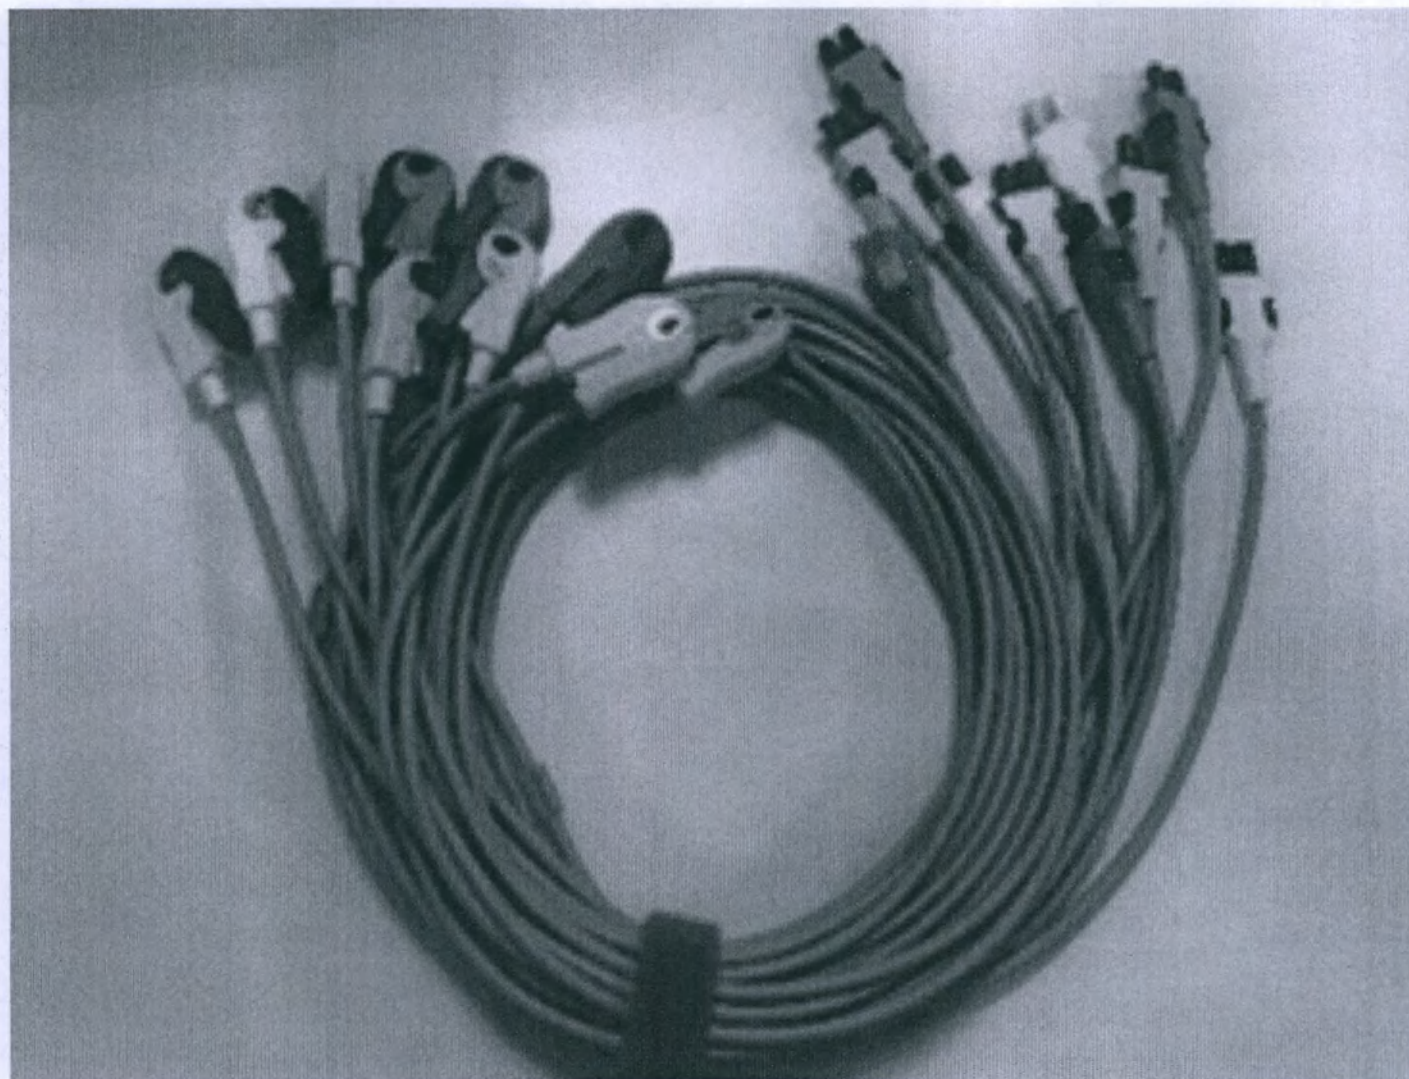


17. Набор дополнительных разъемов для ЭКГ с захватом, ИЕС, 4 шт. в упаковке (не более 10 упаковок) (при необходимости).

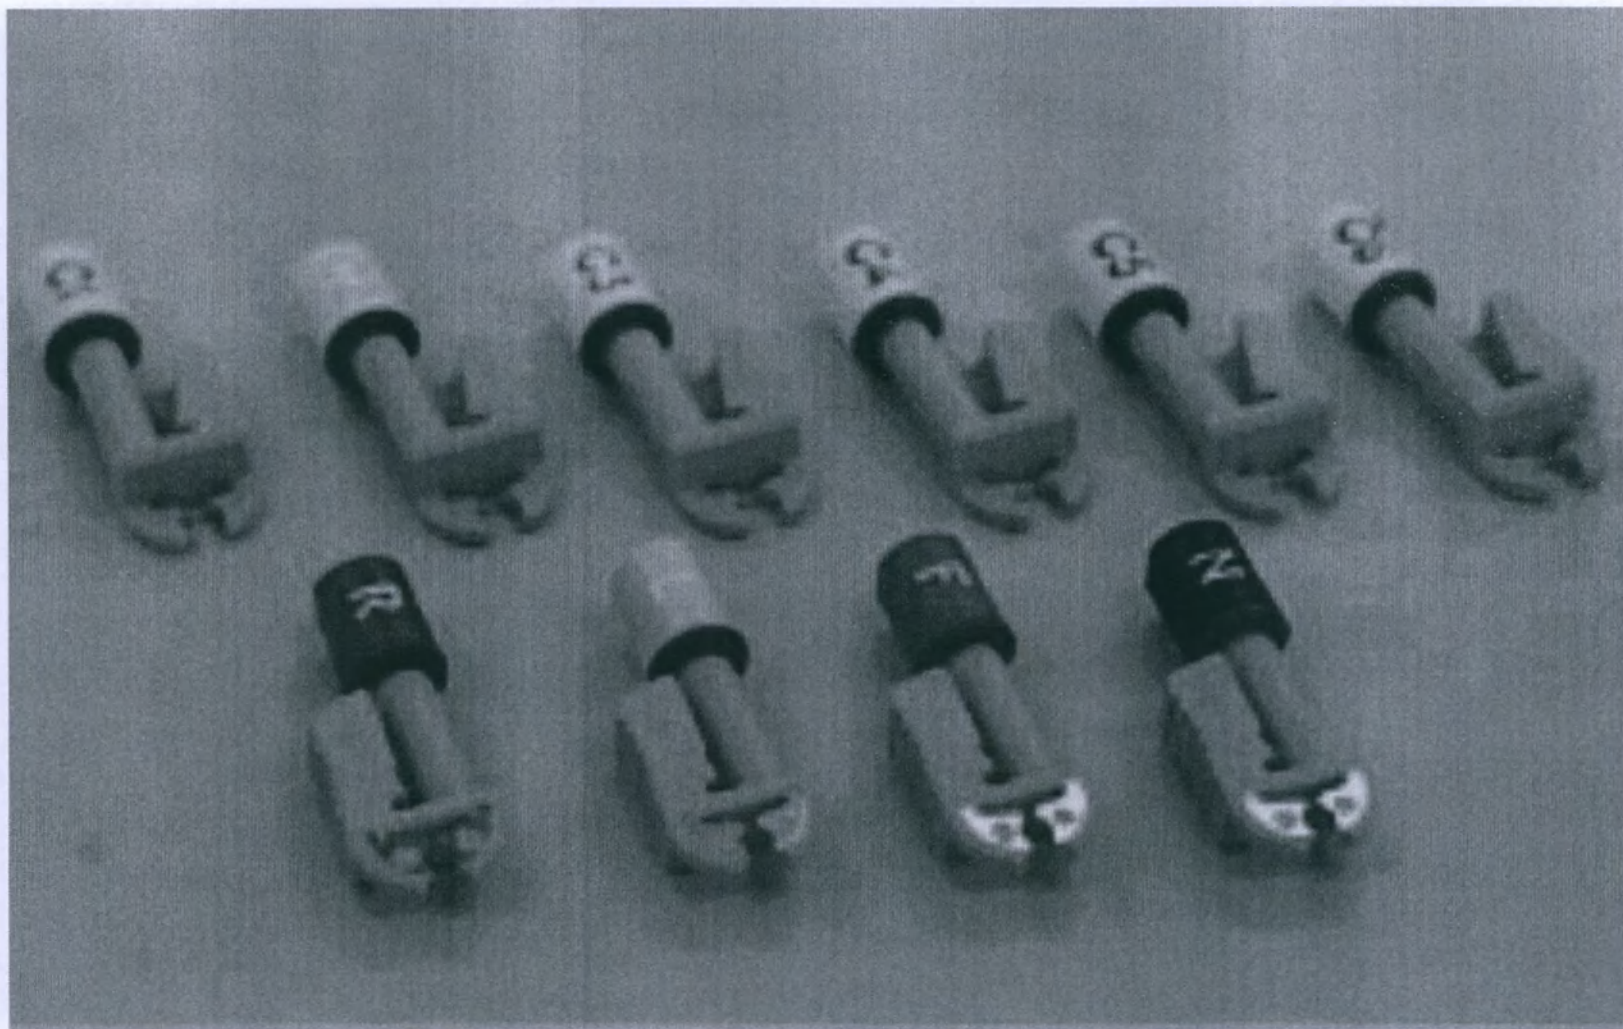


17. Набор дополнительных разъемов для ЭКГ с захватом, ИЕС, 4 шт. в упаковке (не более 10 упаковок) (при необходимости).

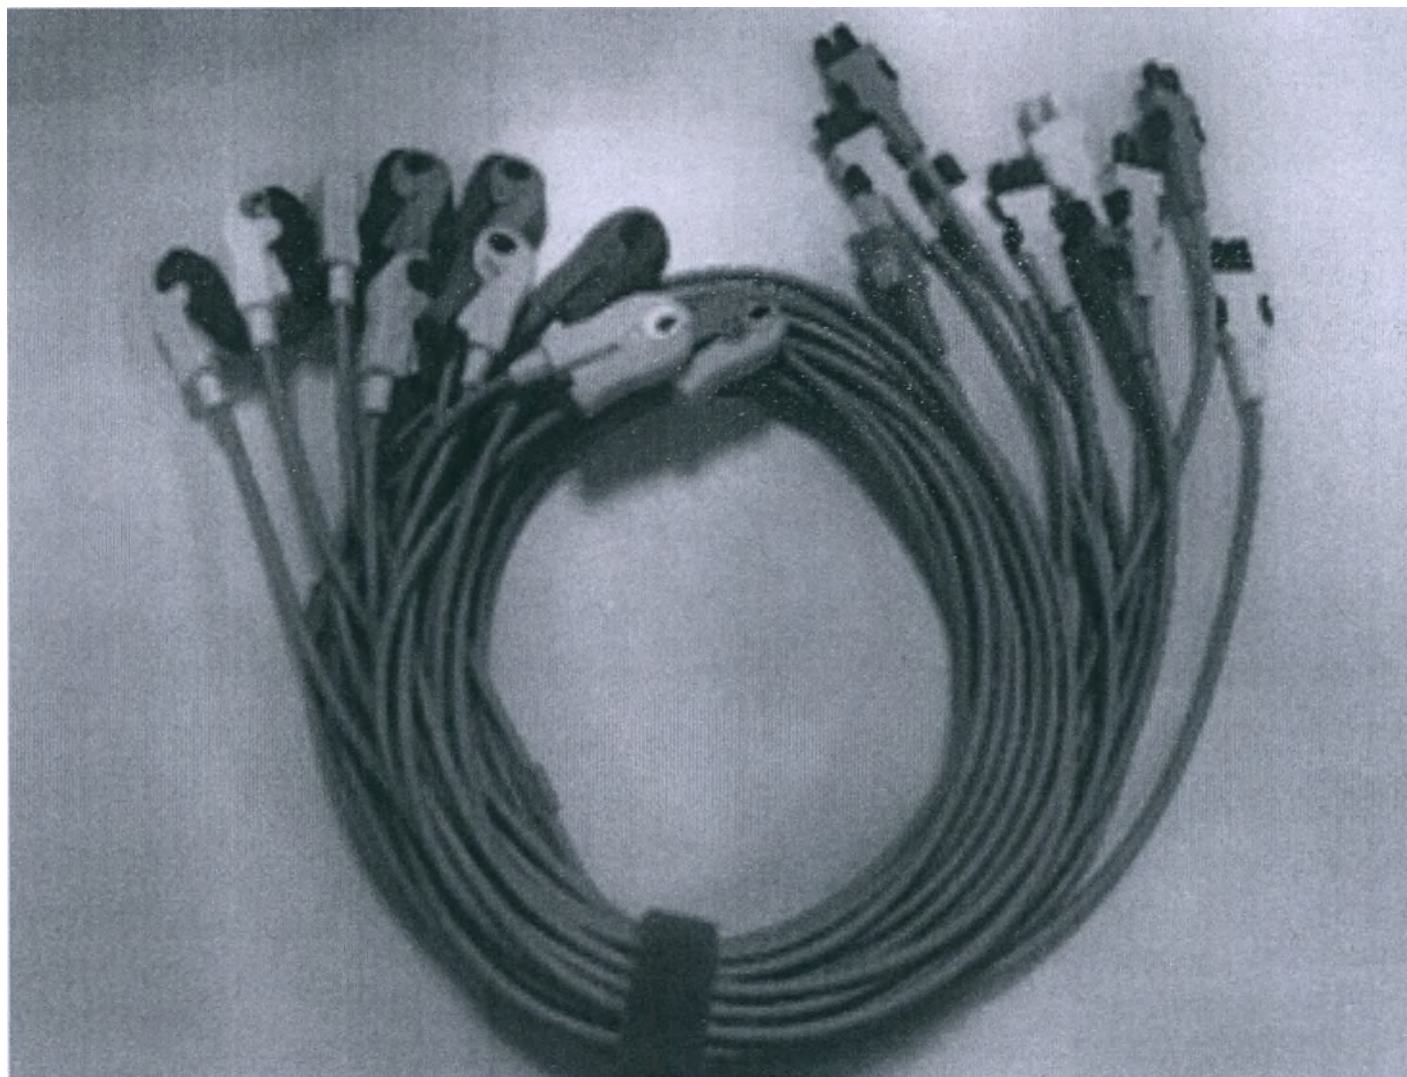


18. Адаптеры-переходники многофункциональные для регистрации ЭКГ с помощью одноразовых электродов (не более 100 шт.) (при необходимости).

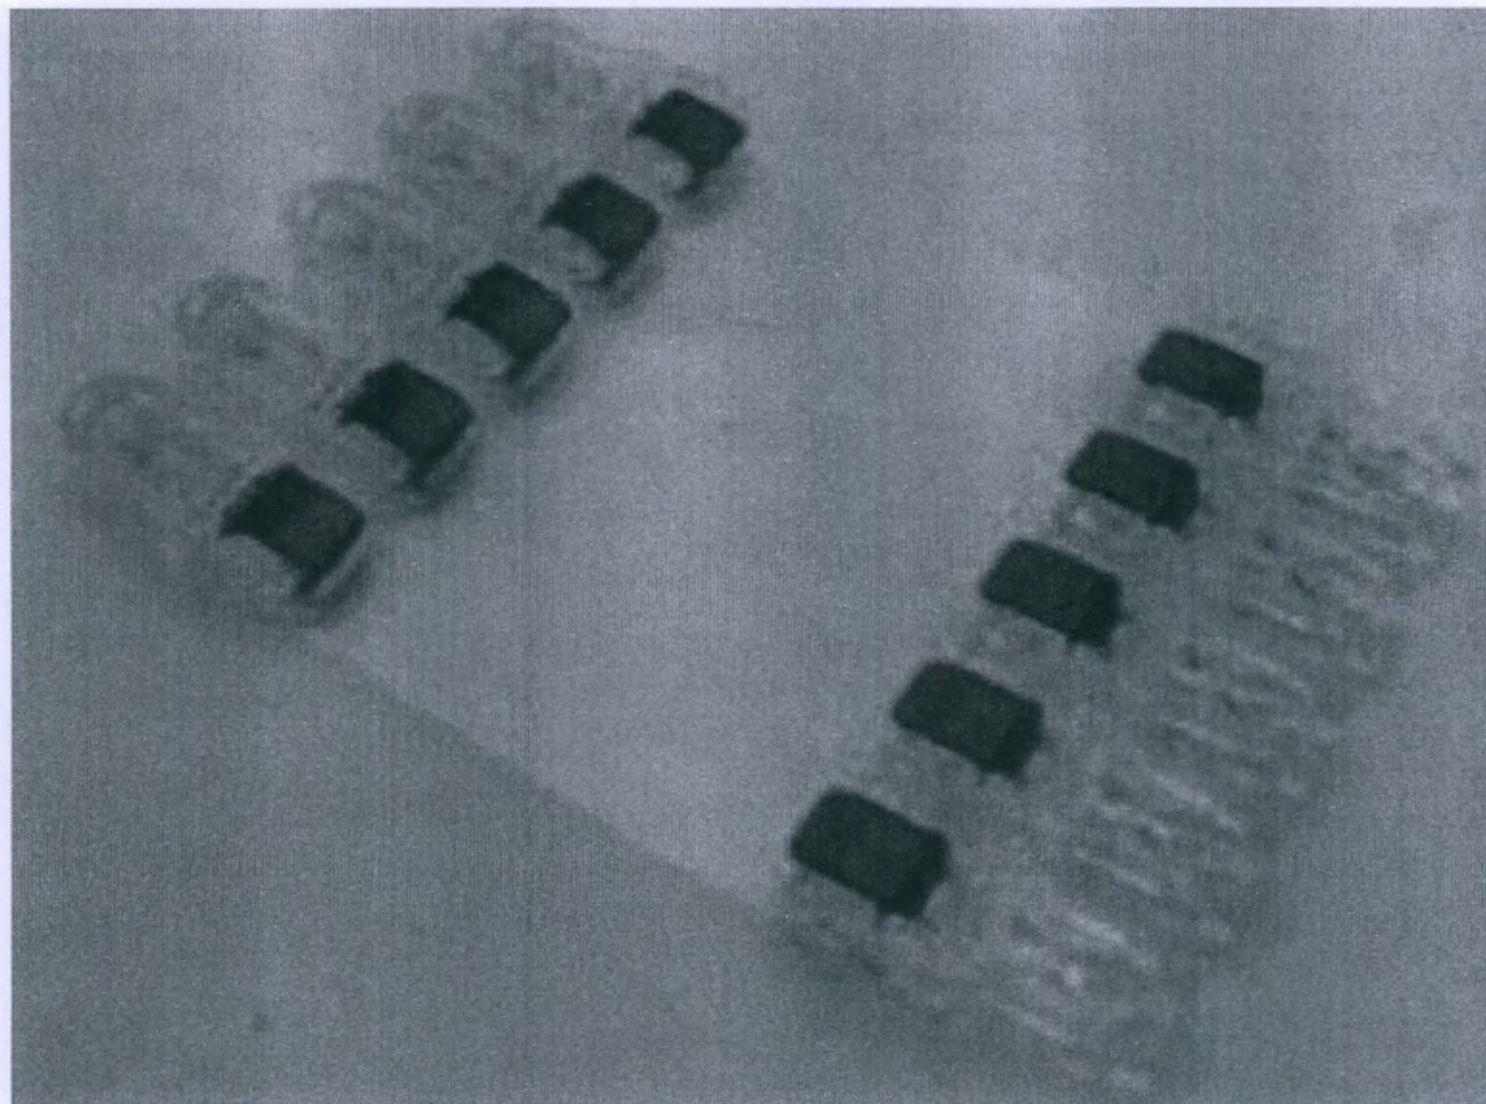


**19. Одноразовые адгезивные электроды маленького размера для снятия ЭКГ у младенцев (не более 12000 шт.)
(при необходимости).**

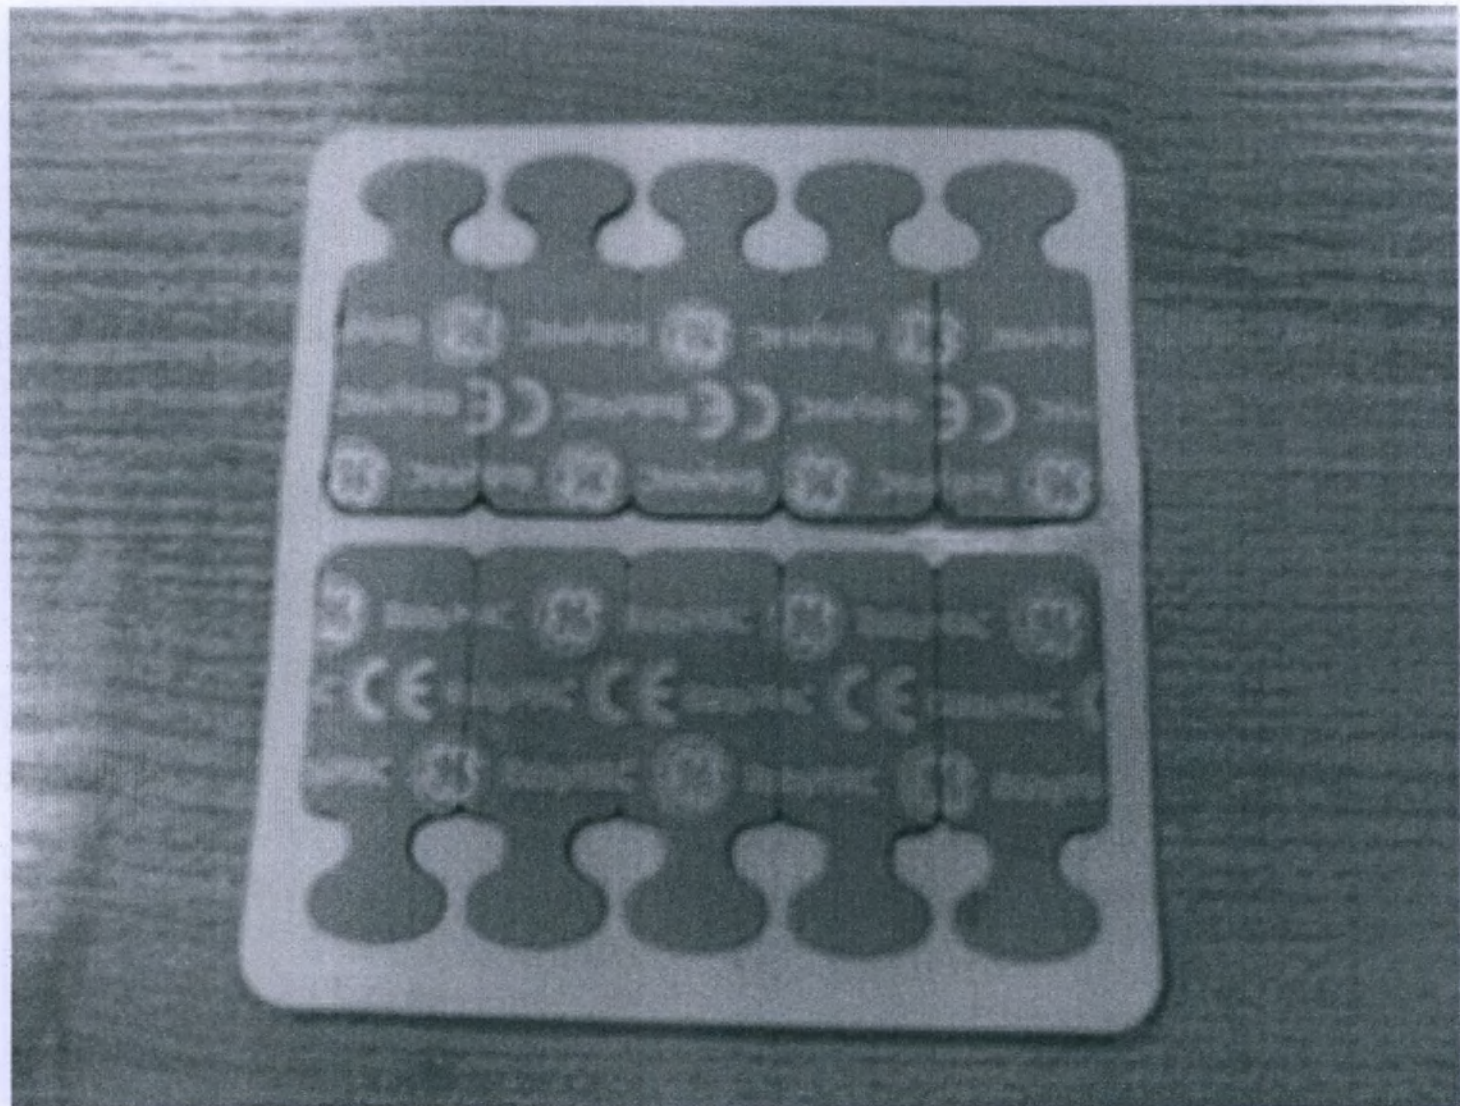

20. Одноразовые адгезивные электроды большого размера для снятия ЭКГ у взрослых (не более 12000 шт.) (при необходимости).

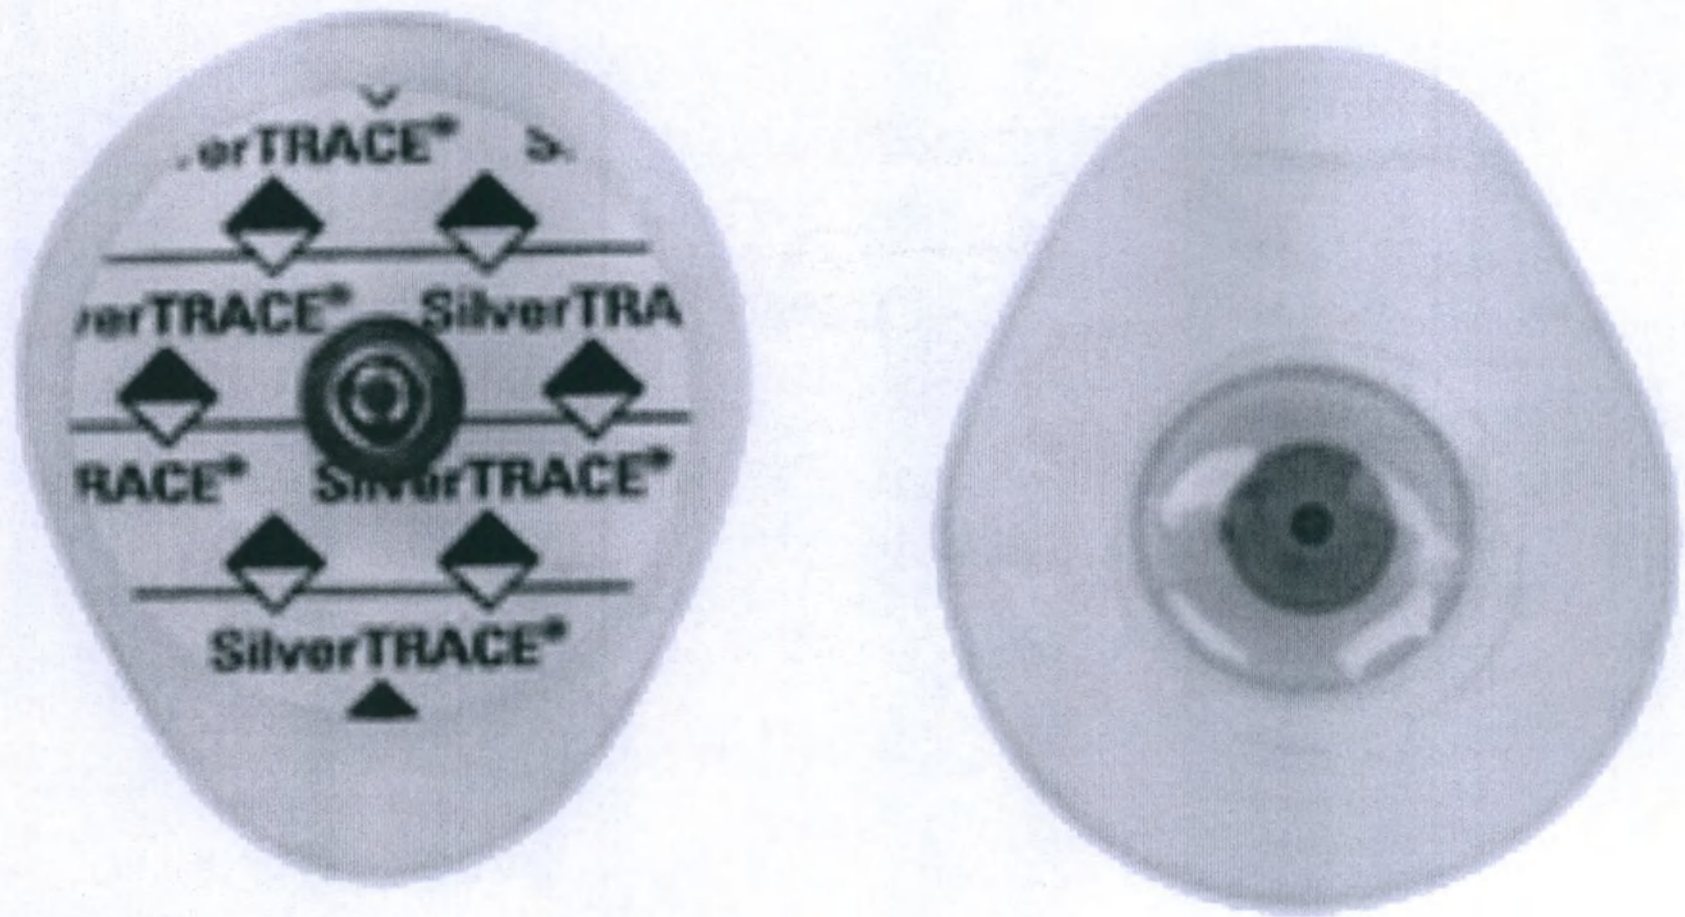


21. Одноразовые адгезивные электроды среднего размера для снятия ЭКГ у детей (не более 12000 шт.) (при необходимости).

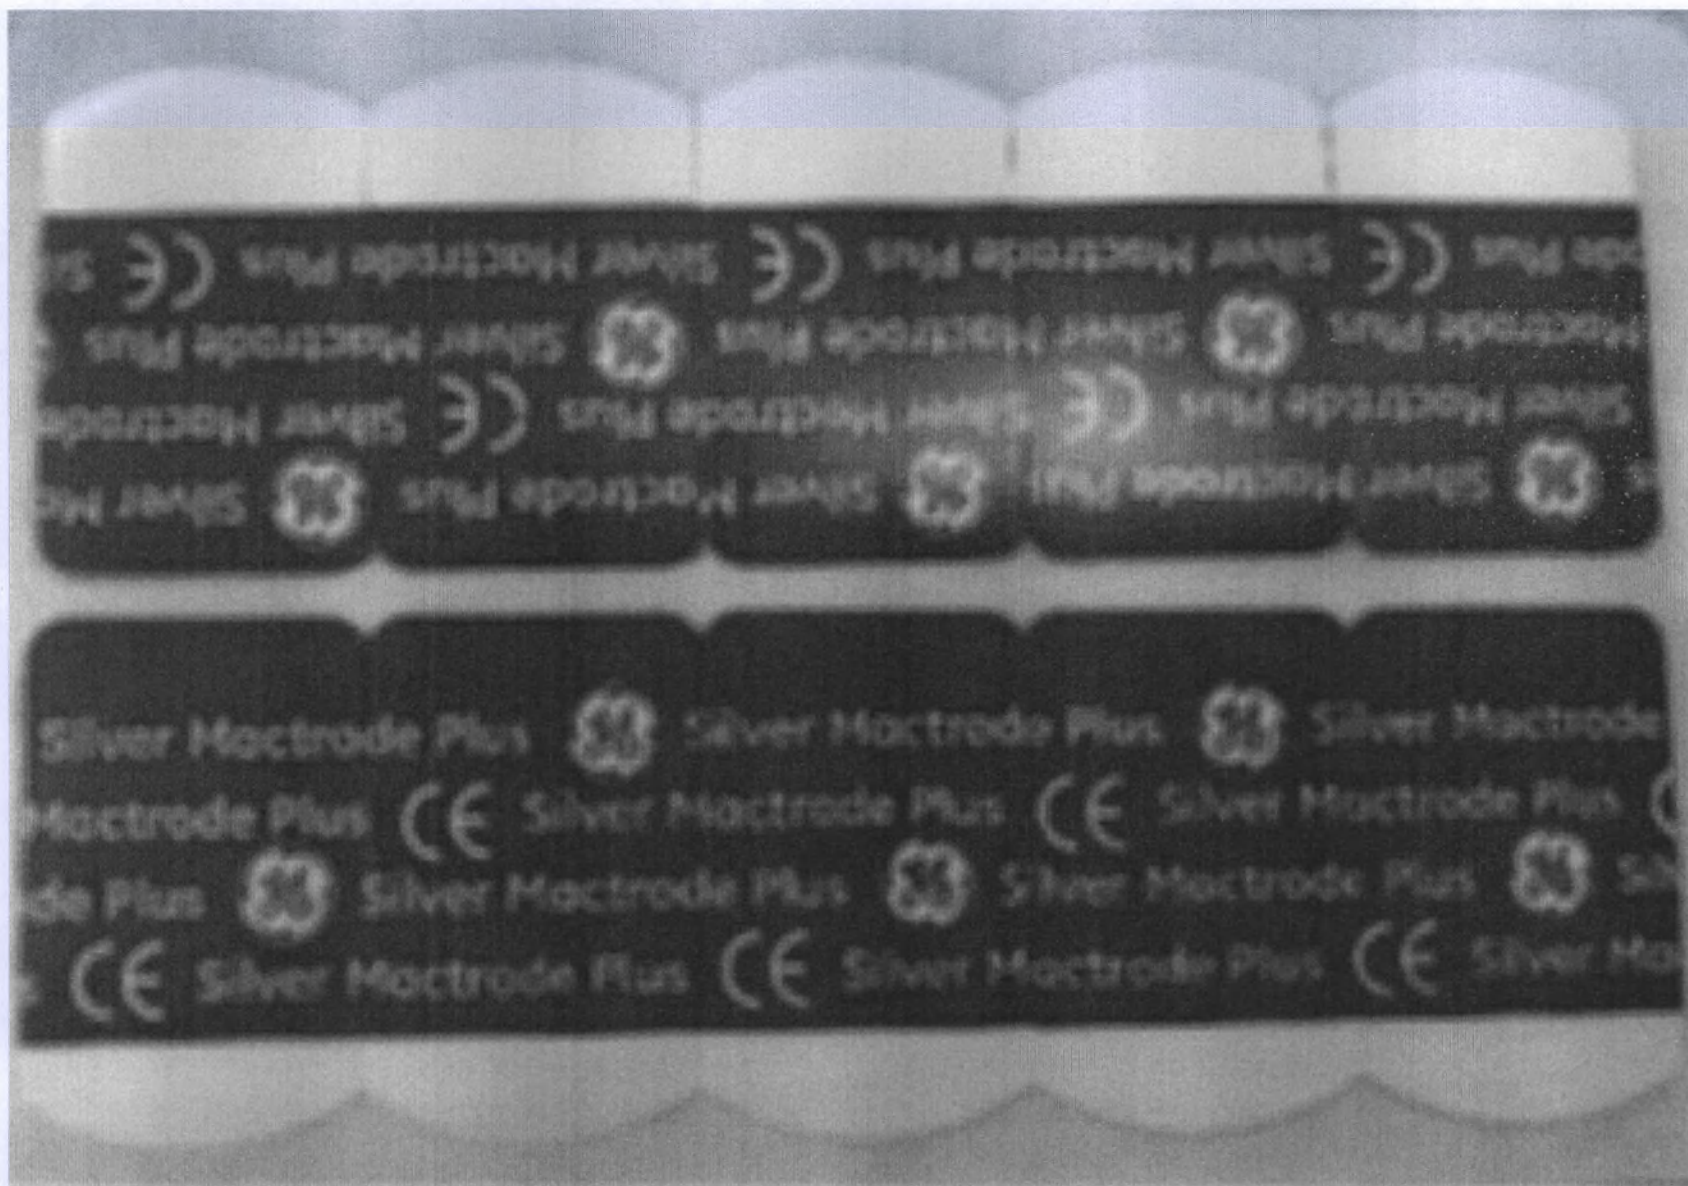

22. Многоразовый шаровой электрод Уэлша в форме груши (не более 50 шт.) (при необходимости).



23. Многоразовый электрод в форме прищепки для конечностей (не более 50 шт.) (при необходимости).

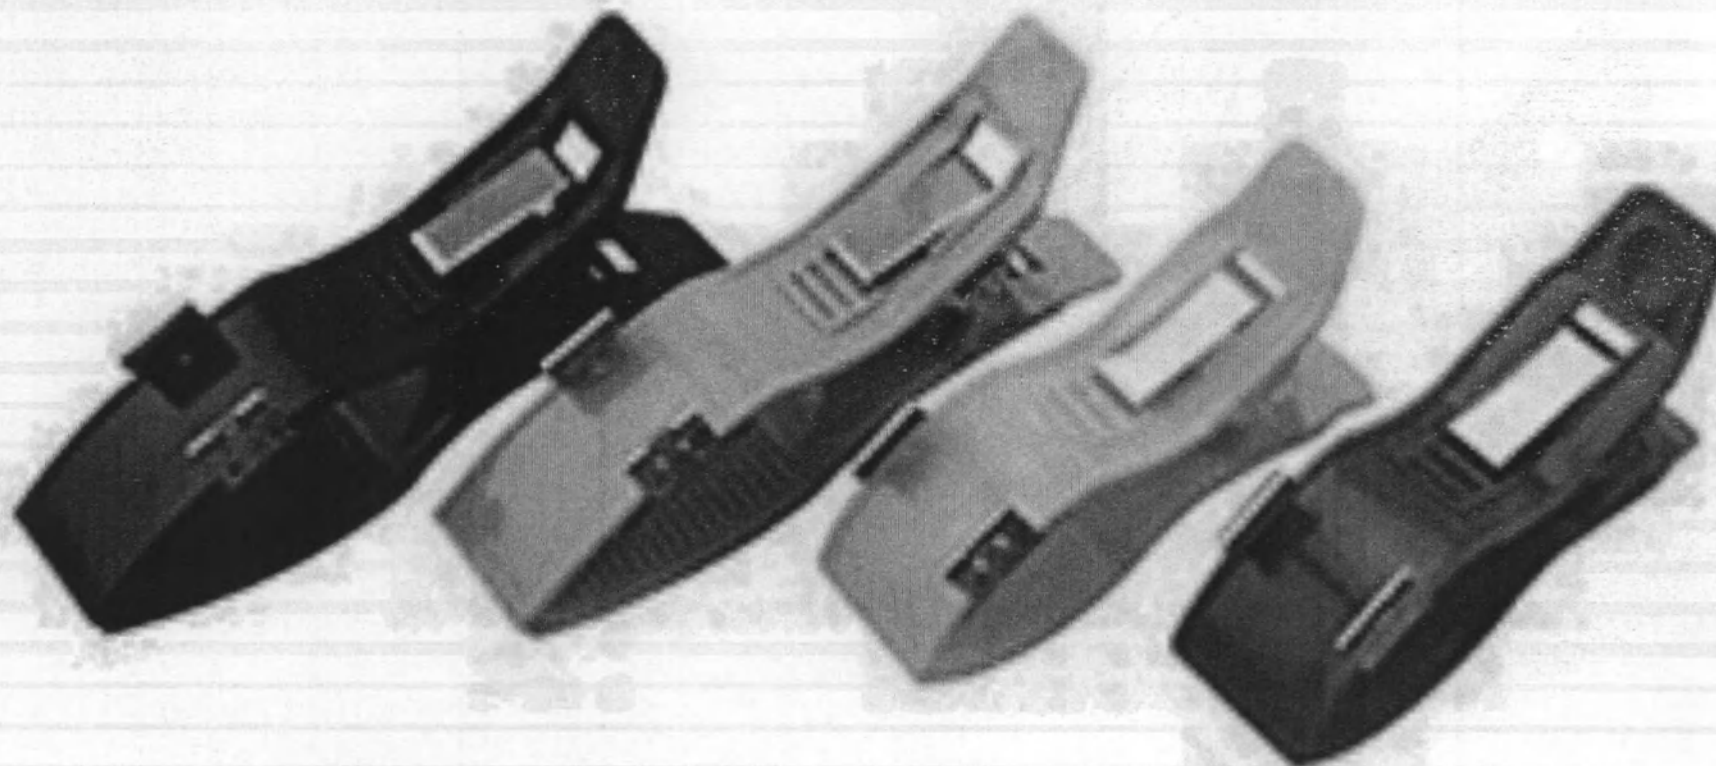

Электрокардиограф МАС в вариантах исполнения


Электрокардиограф МАС 600

Краткое справочное руководство



Услуги по обучению
Совершенствование клинических исследований


Принадлежности: 1. Аккумуляторная литий-ионная батарея (не более 5 шт.)

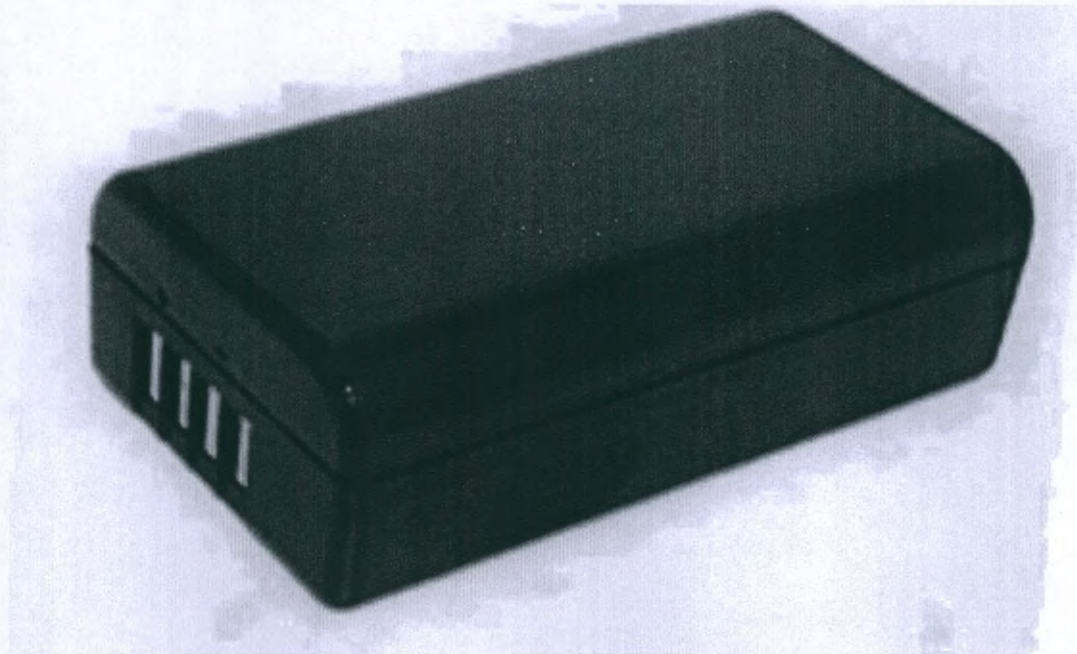


2. Сумка переносная для электрокардиографа с карманами для аксессуаров (не более 10 шт.)




3. Специальная термочувствительная бумага для распечатки ЭКГ (не более 3000 пач.)

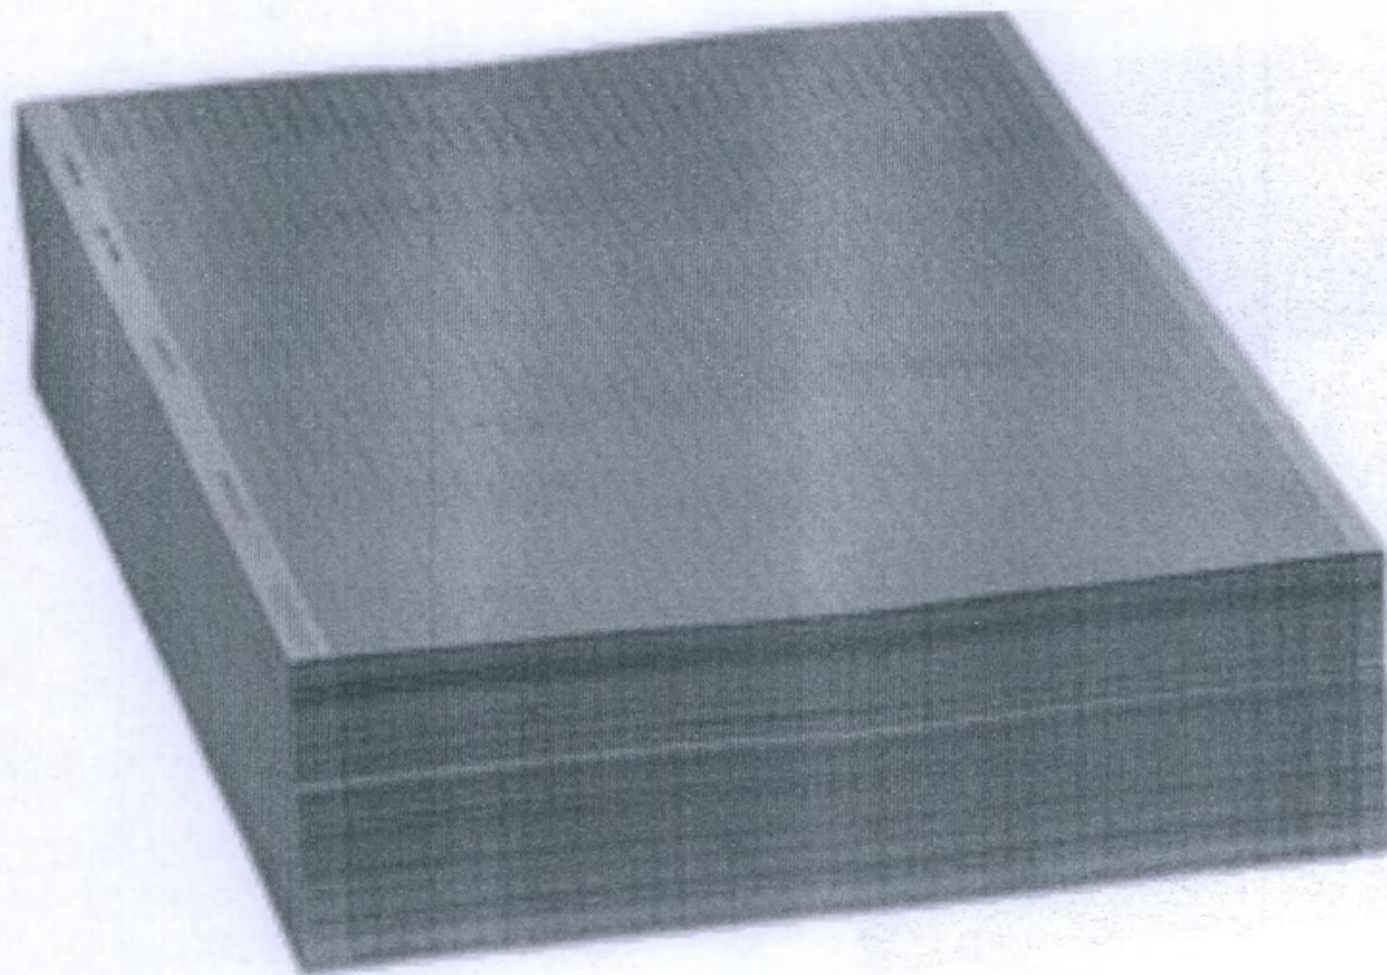

4. Термочувствительная бумага для распечатки ЭКГ (не более 1000 шт.)

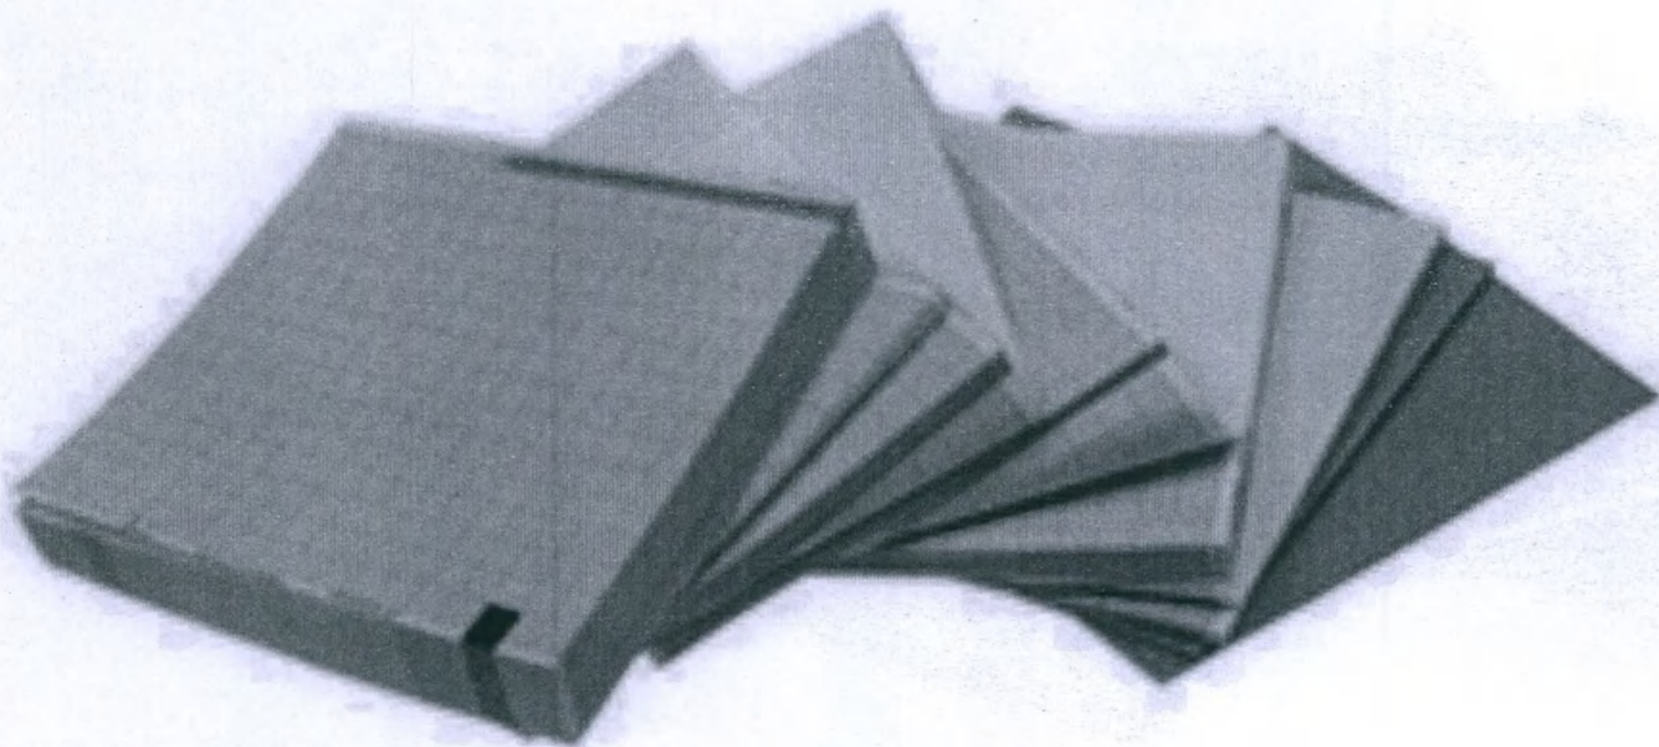

5. Кабель для передачи аналогового сигнала через серийный COM-порт

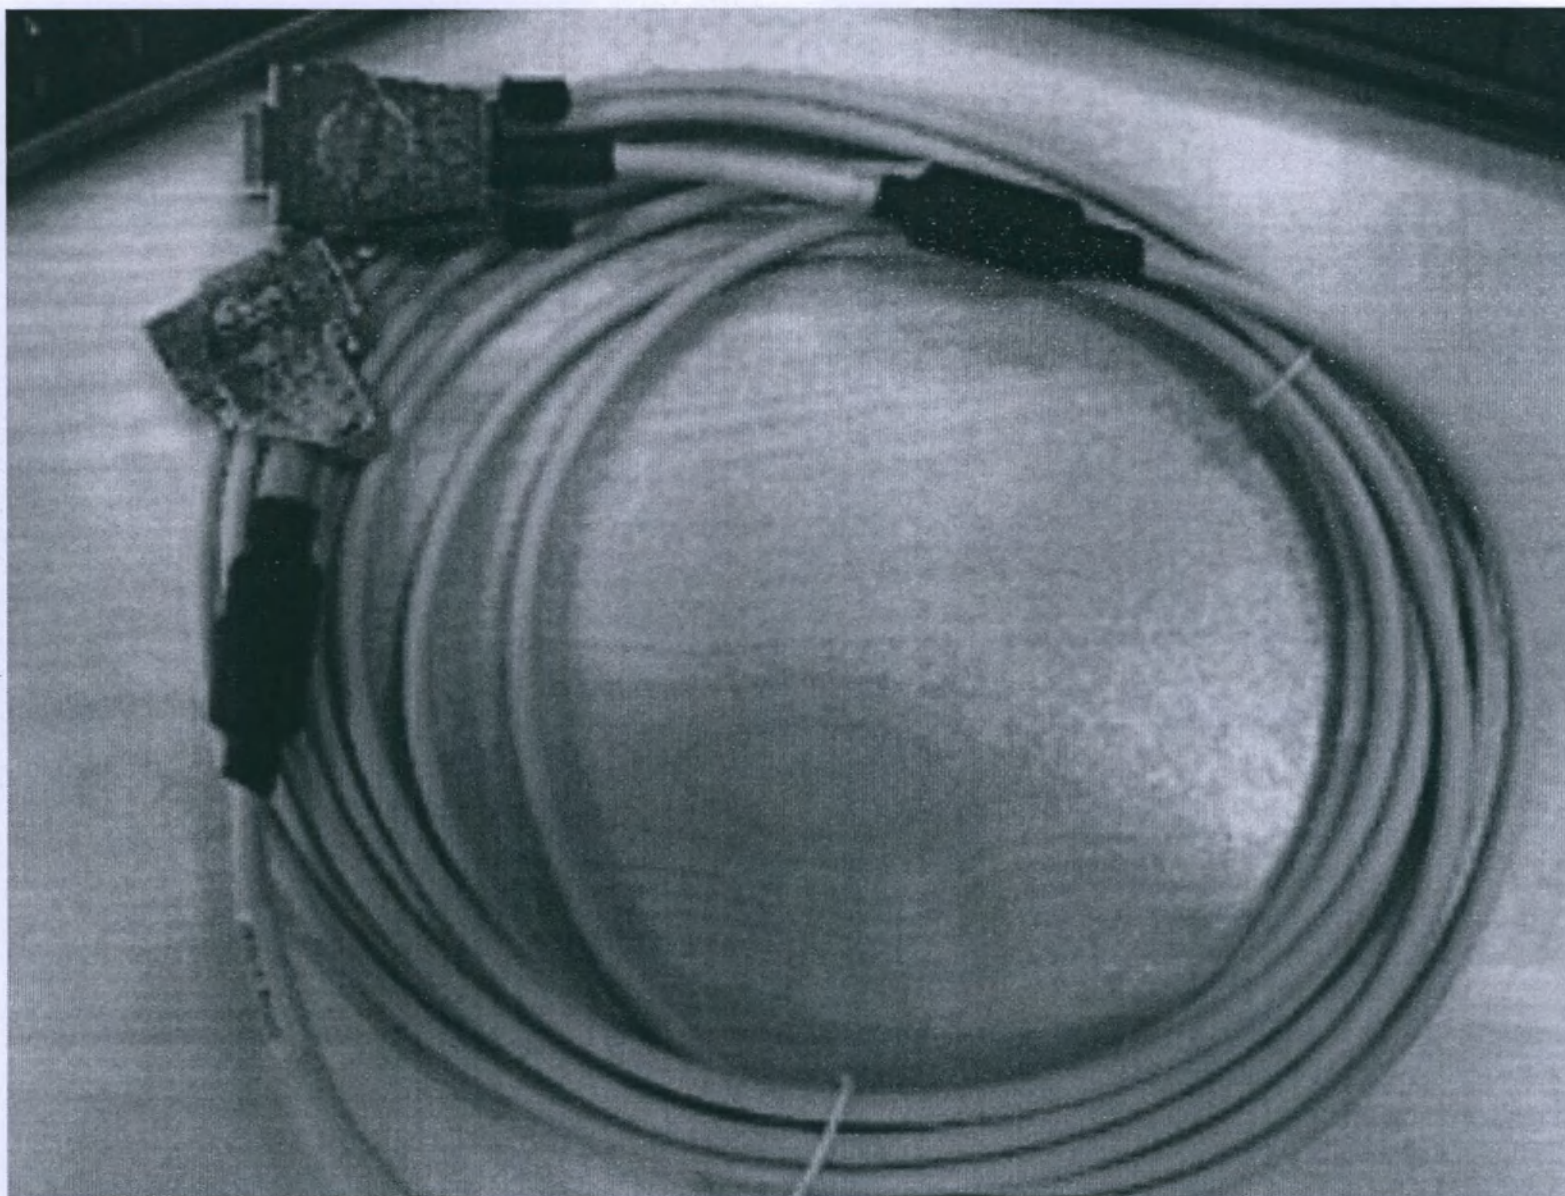


6. Кабель сетевой типа Ethernet для подключения к локальной сети (не более 5 шт.)



7. Карта памяти.




8. Оптический или электронный носитель с документацией.

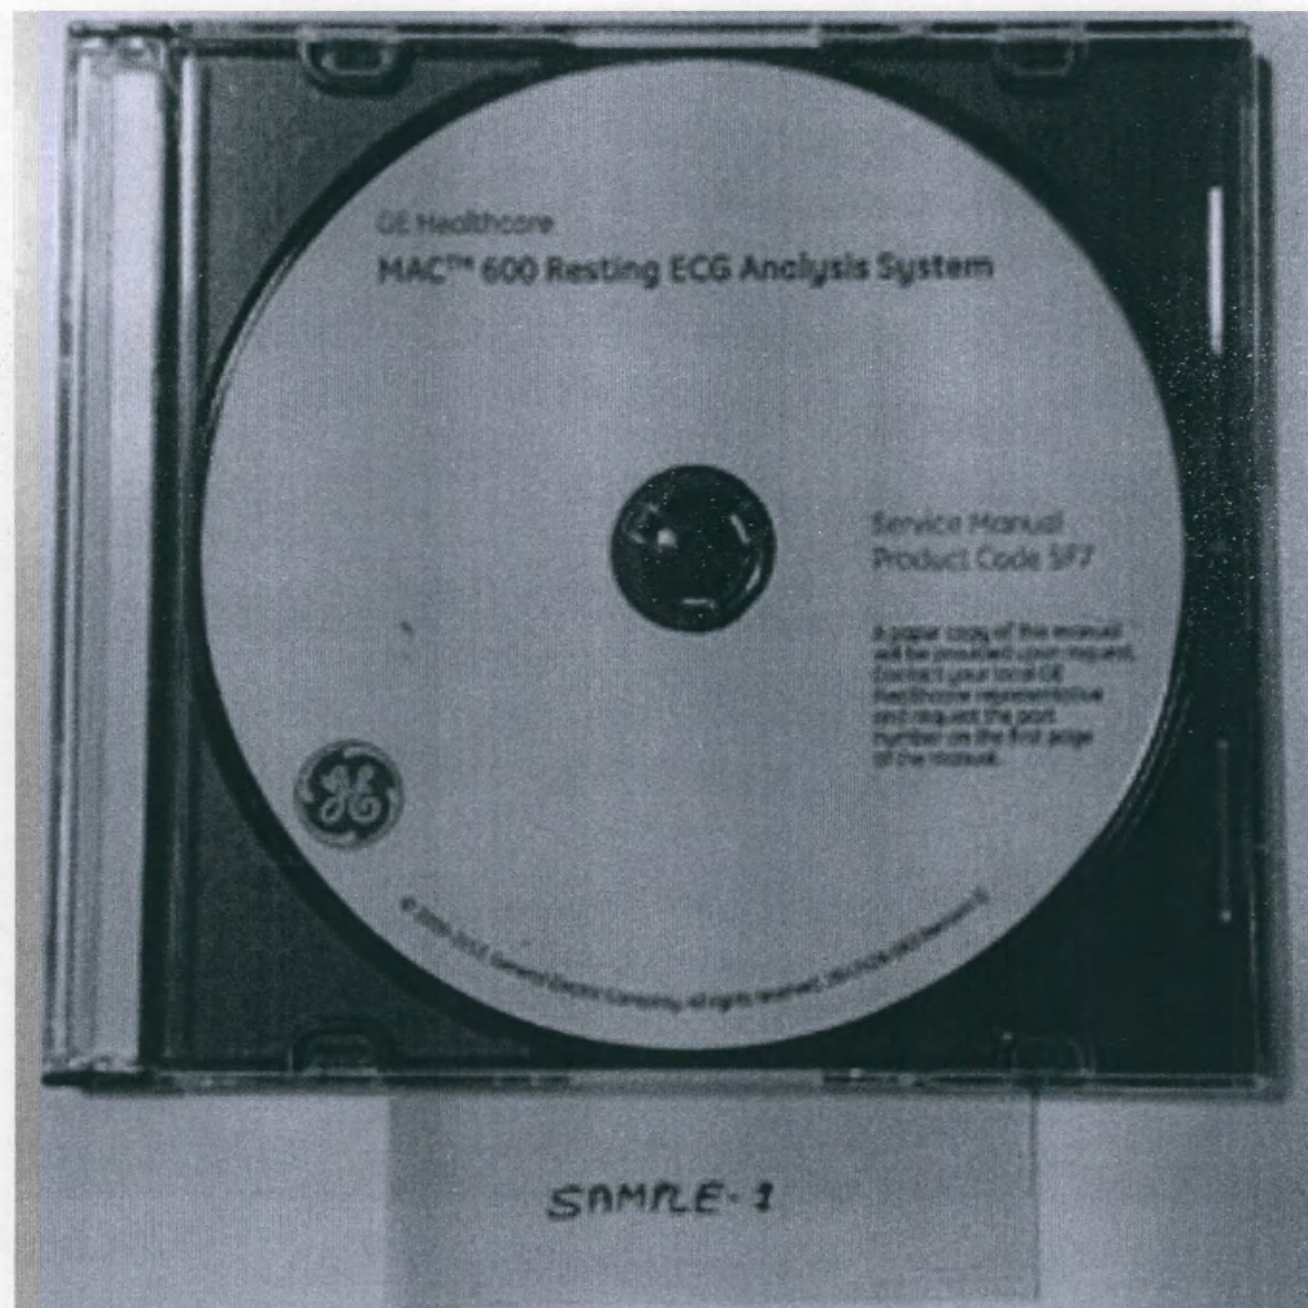


9. Лицензионный ключ для ПК.




10. Материнская плата электрокардиографа с электронными компонентами , производитель GE Medical Systems Information Technologies, Inc., США.

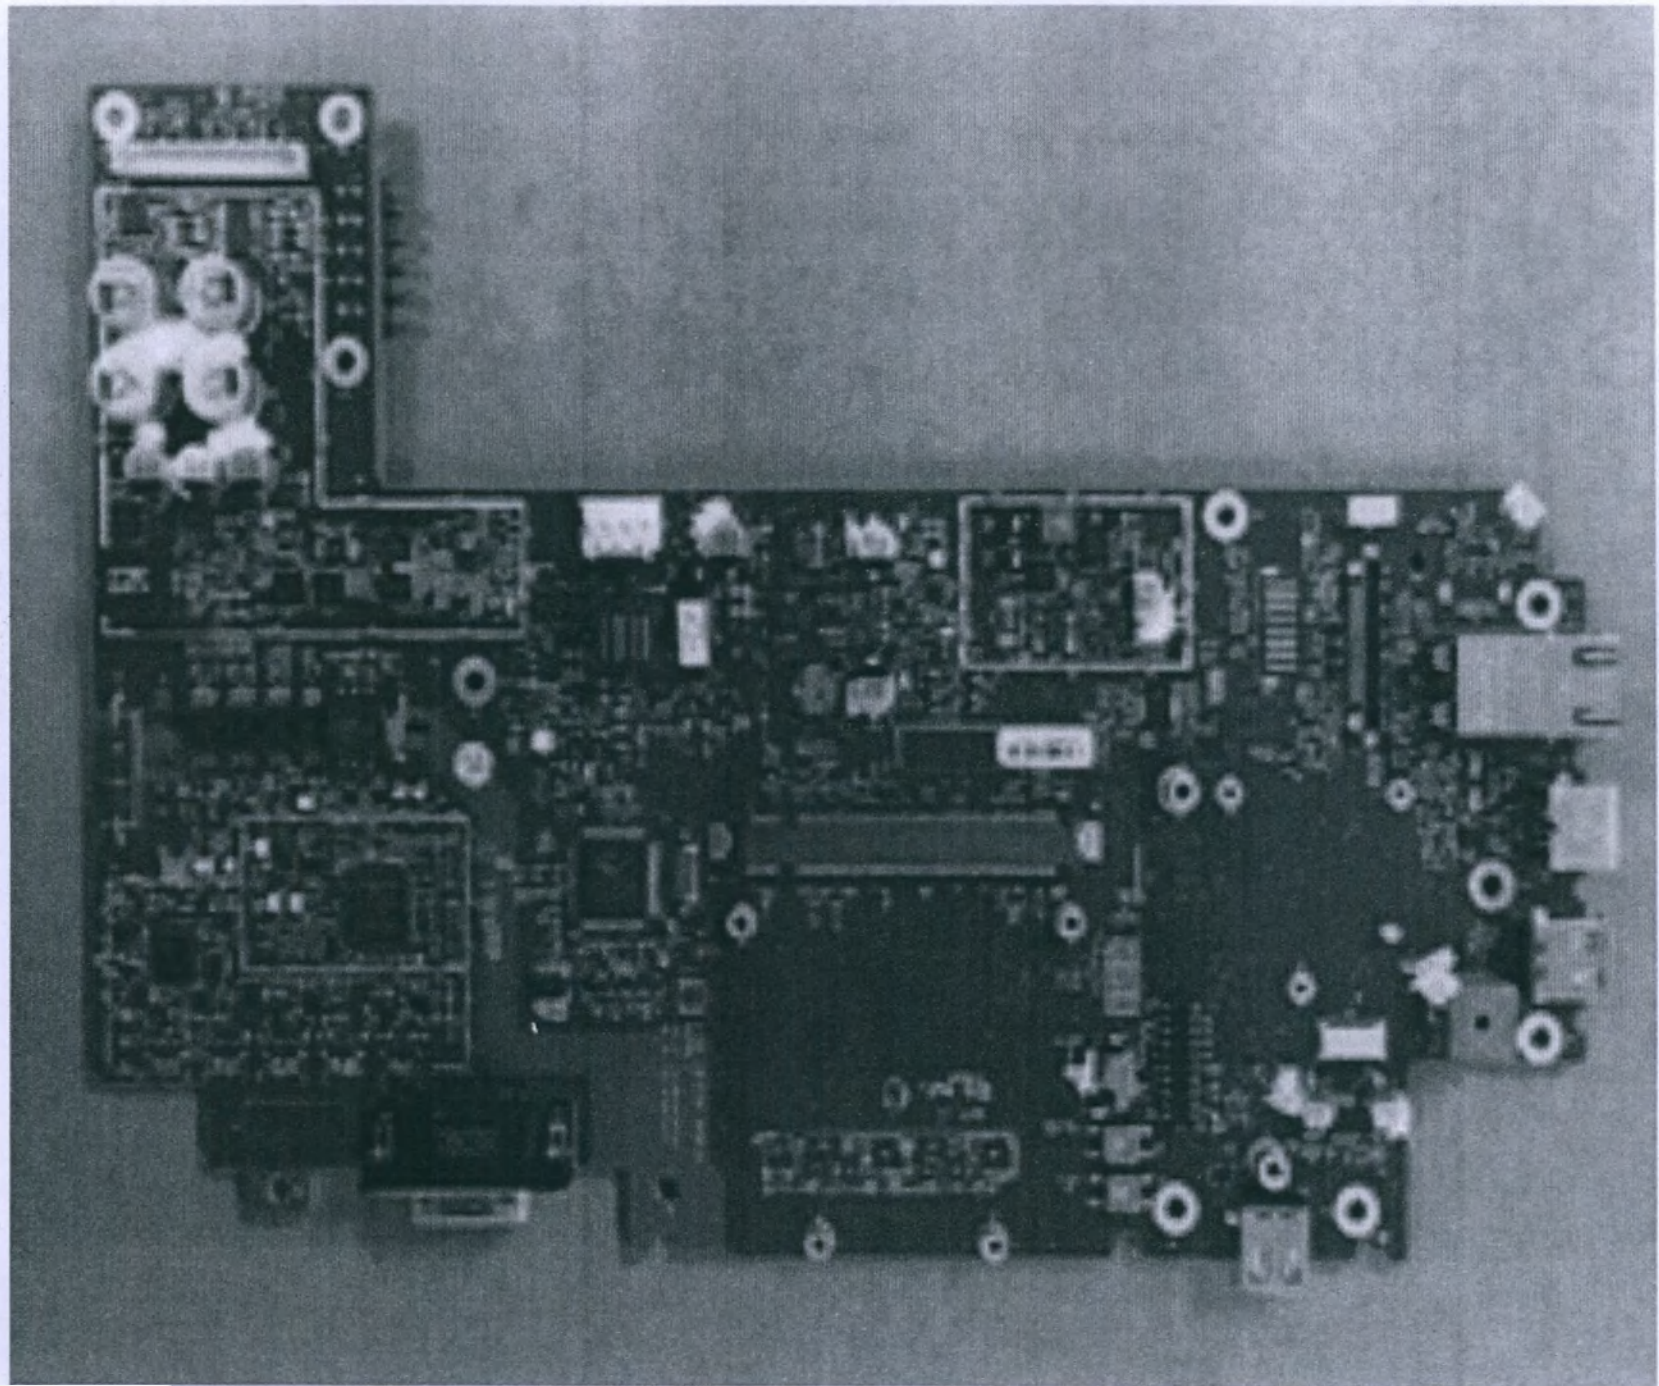


11. Модуль беспроводной передачи данных, подключаемый через COM-порт (не более 2шт.)

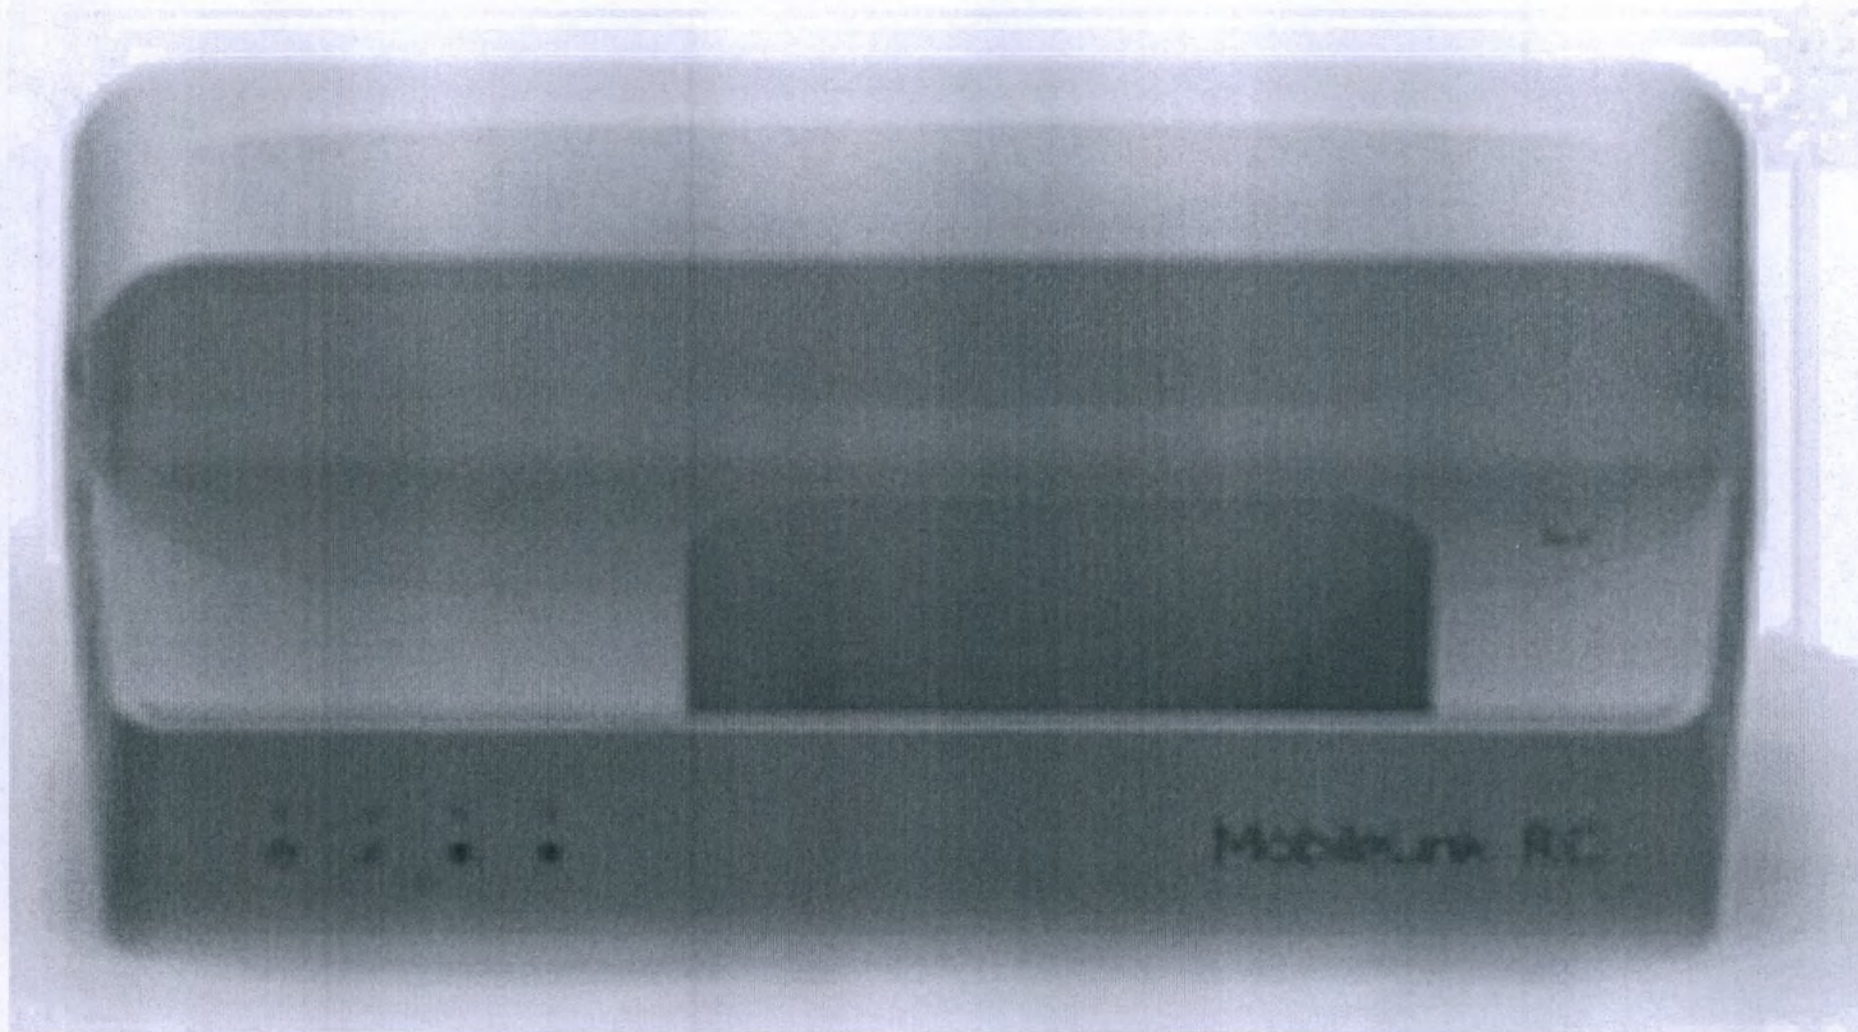


12. Модуль ЖК дисплея, производитель GE Medical Systems Information Technologies, Inc., США.

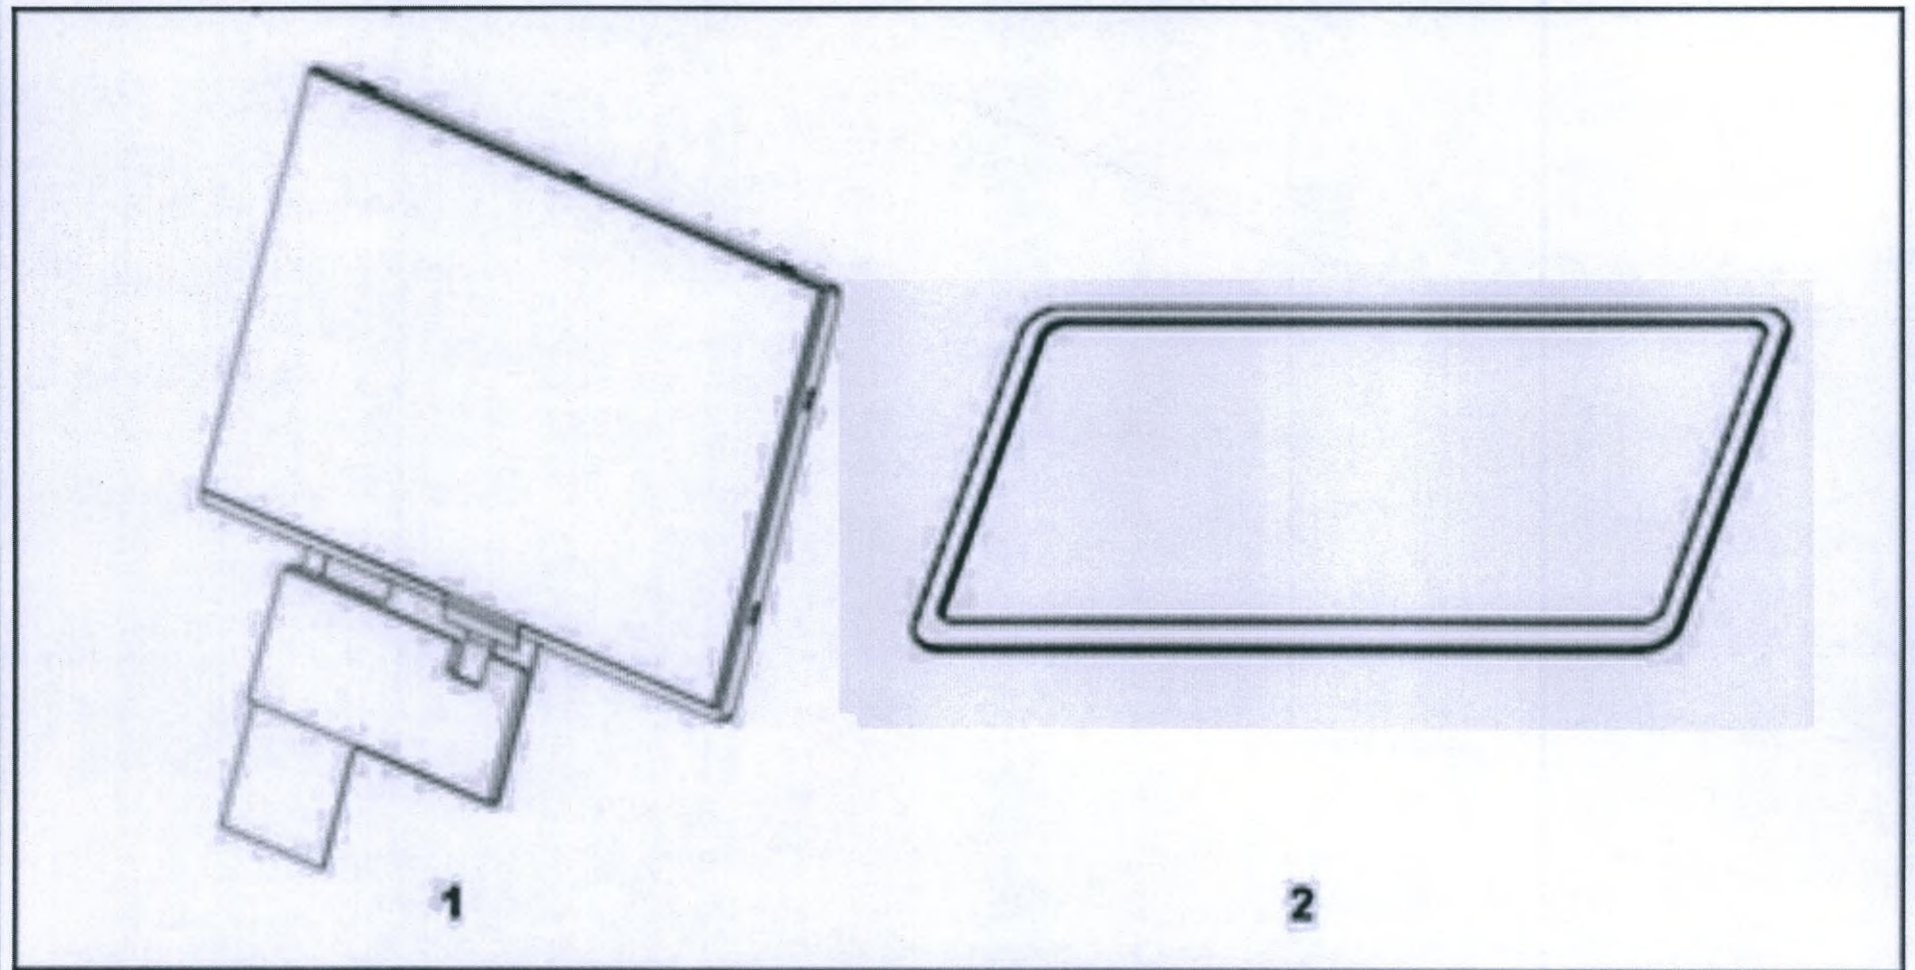


13. Программный ключ активации измерения ЭКГ на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

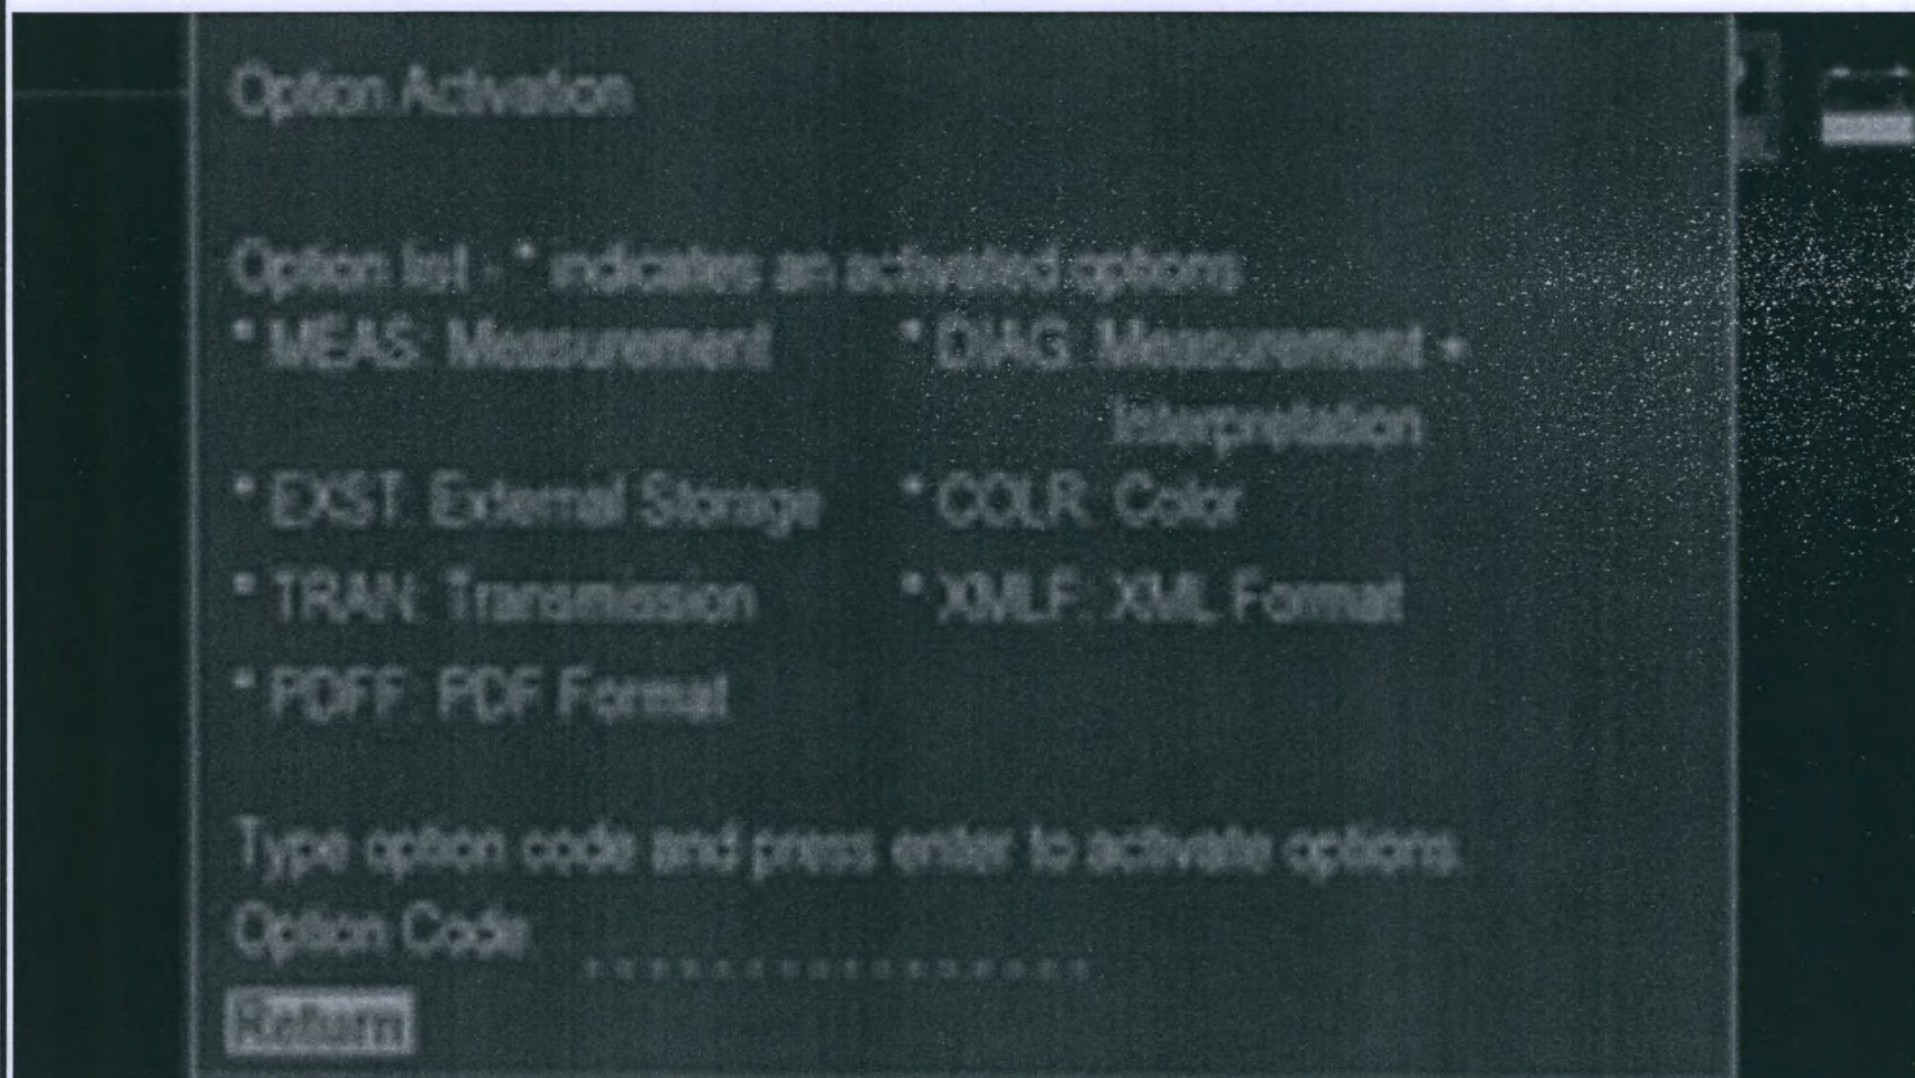


14. Программный ключ активации измерения и интерпретации ЭКГ на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

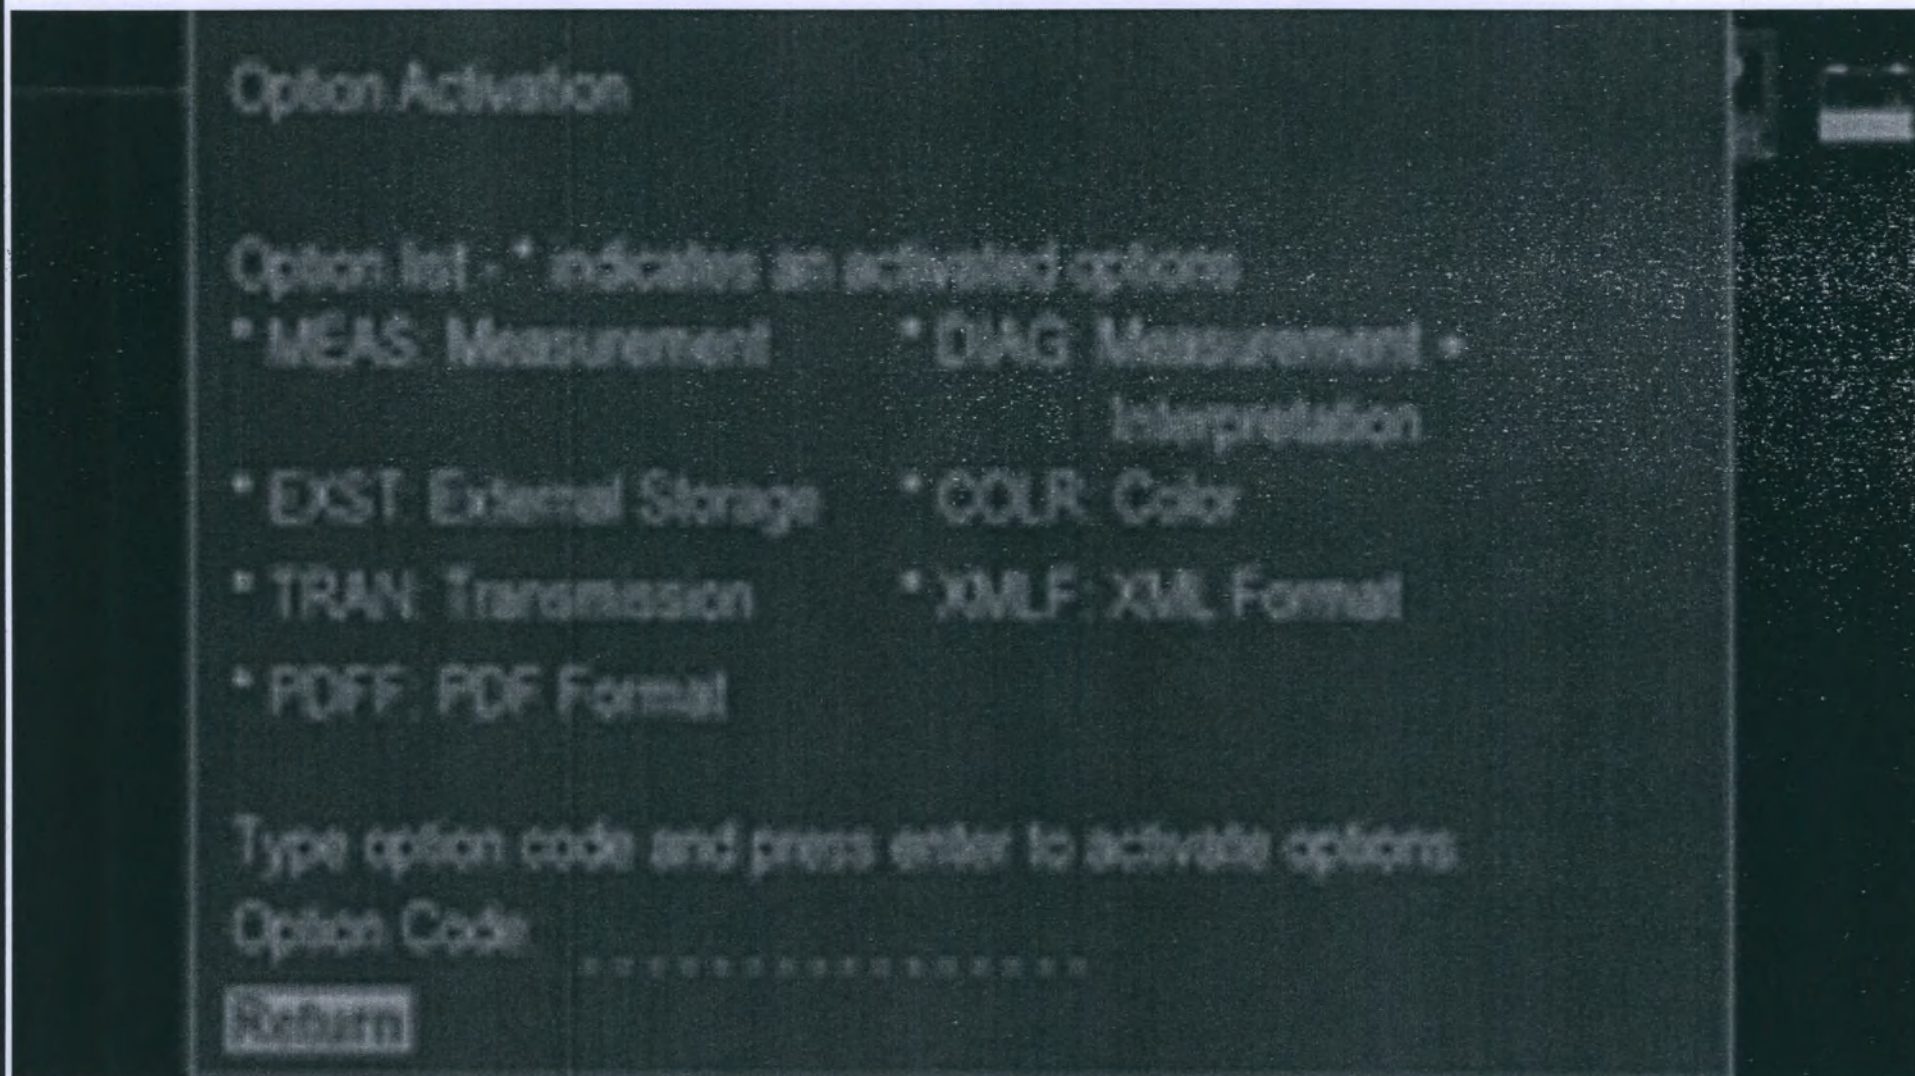


15. Программный ключ активации измерения и интерпретации ЭКГ, памяти для хранения ЭКГ и экспорта в формат PDF/XML на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

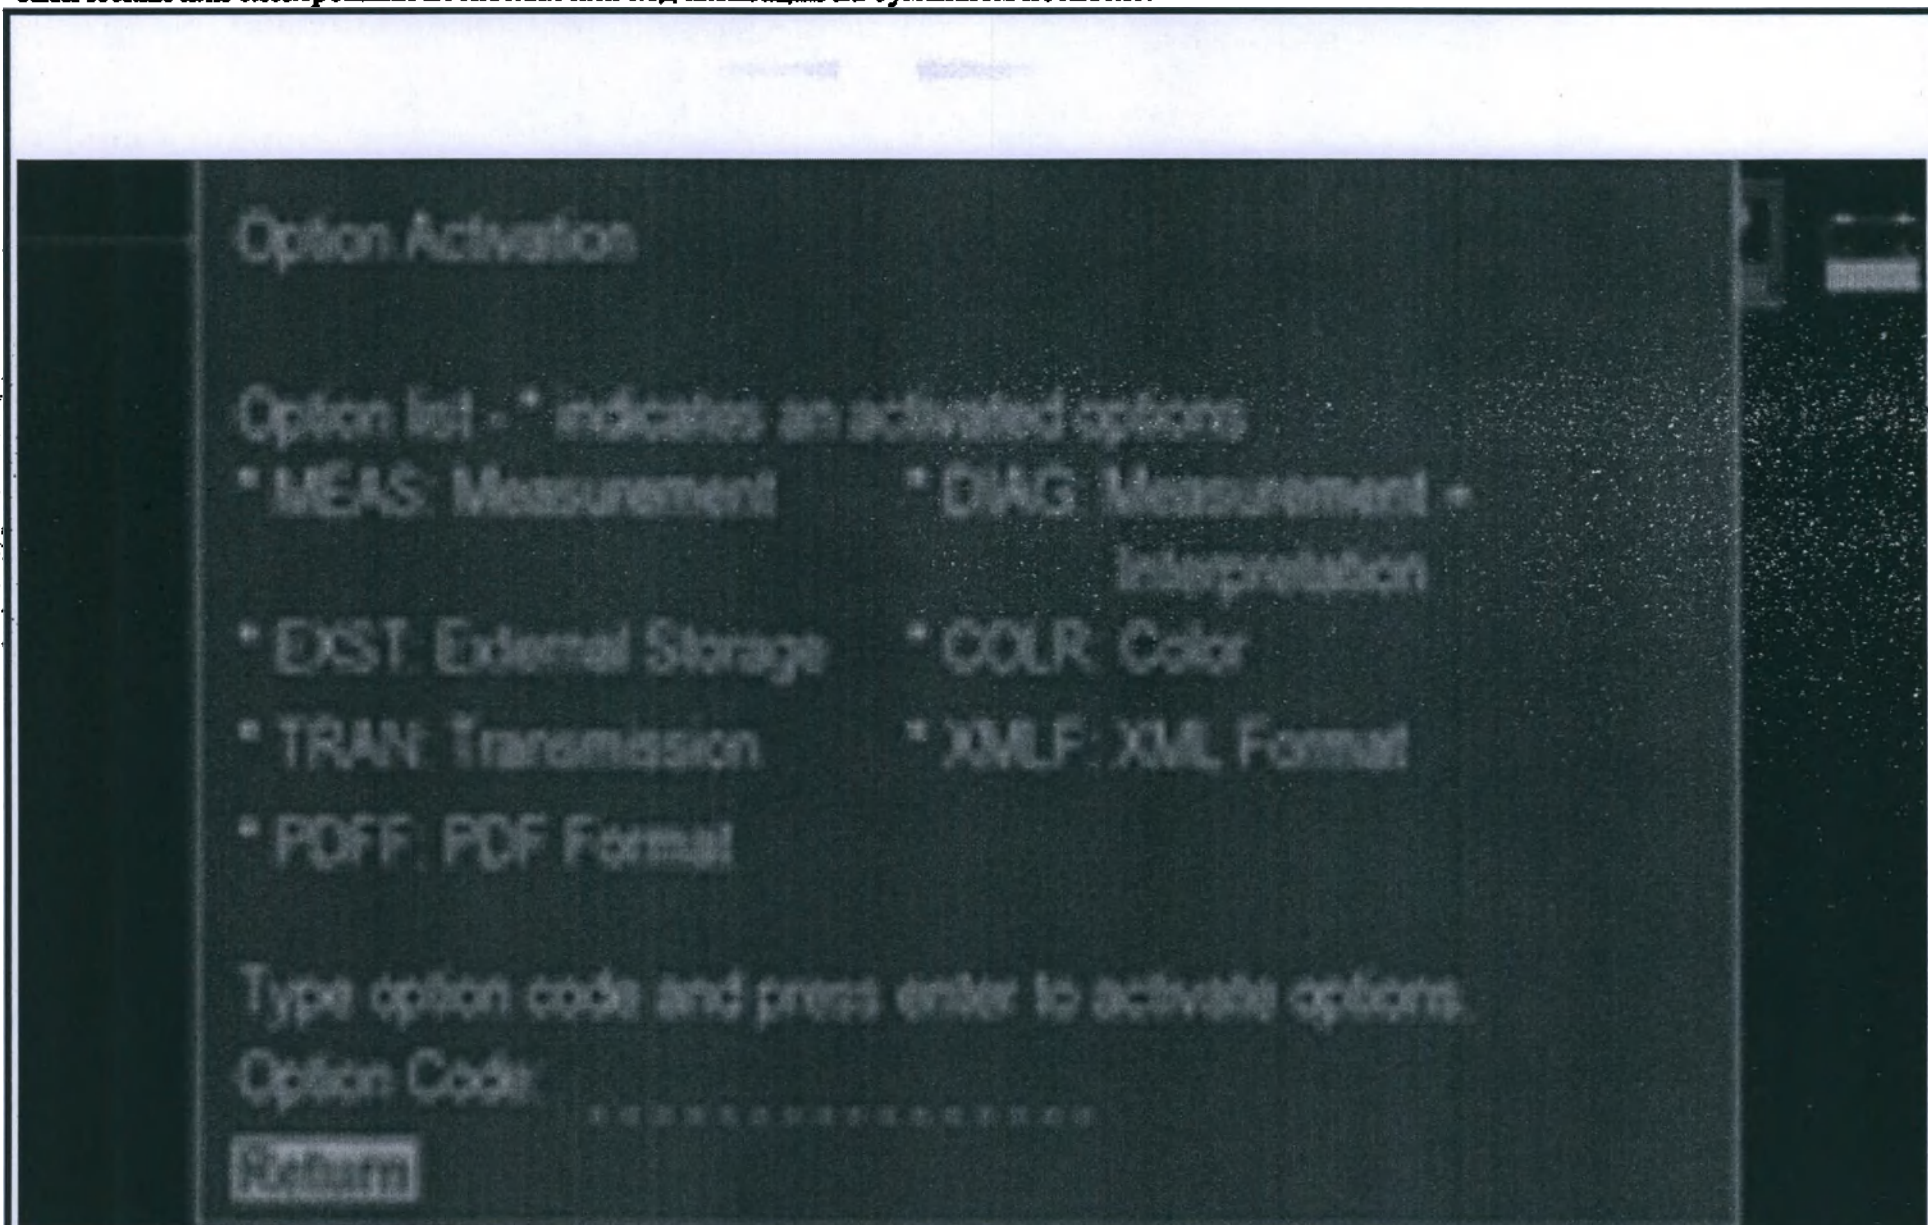


16. Программный ключ активации измерения и интерпретации ЭКГ, памяти для хранения ЭКГ, экспорта в формат PDF/XML и передачи данных в кардиологическую систему на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе.

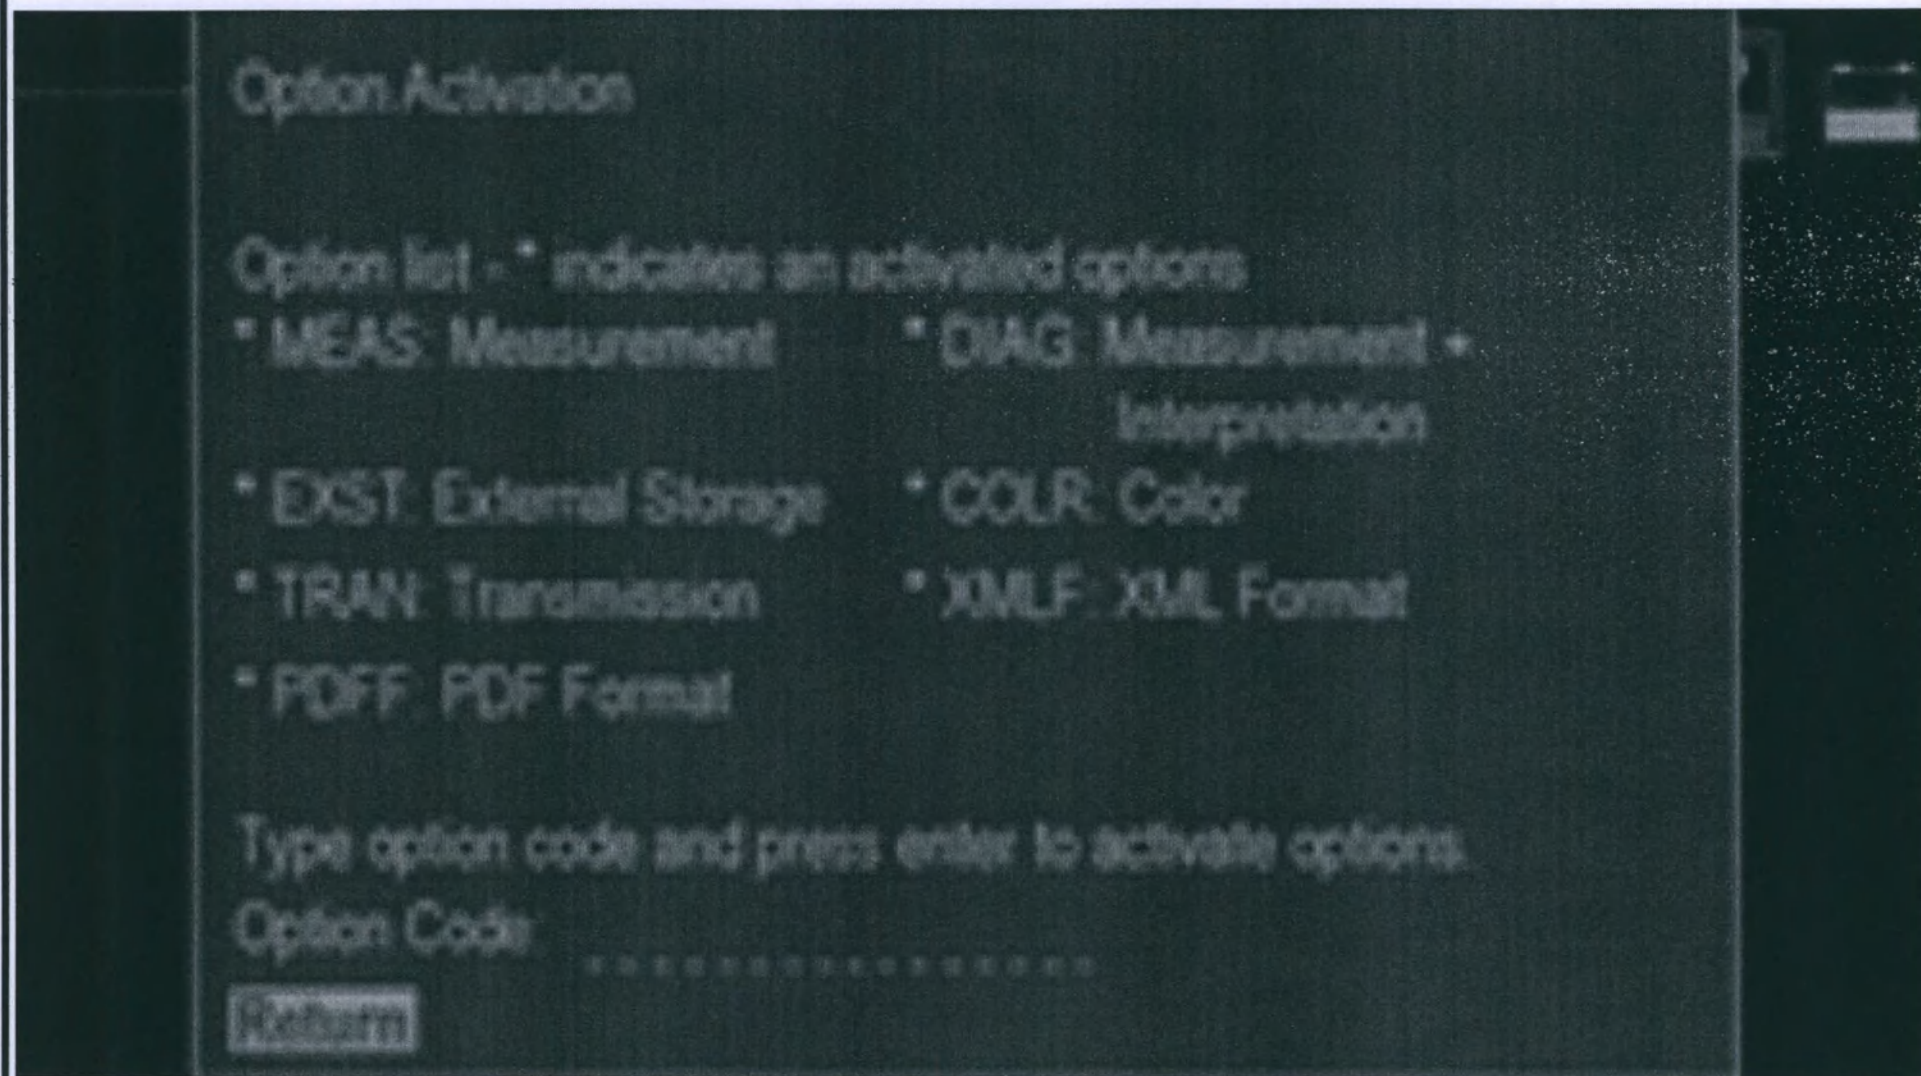


17. Программный ключ активации измерения и интерпретации ЭКГ на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.

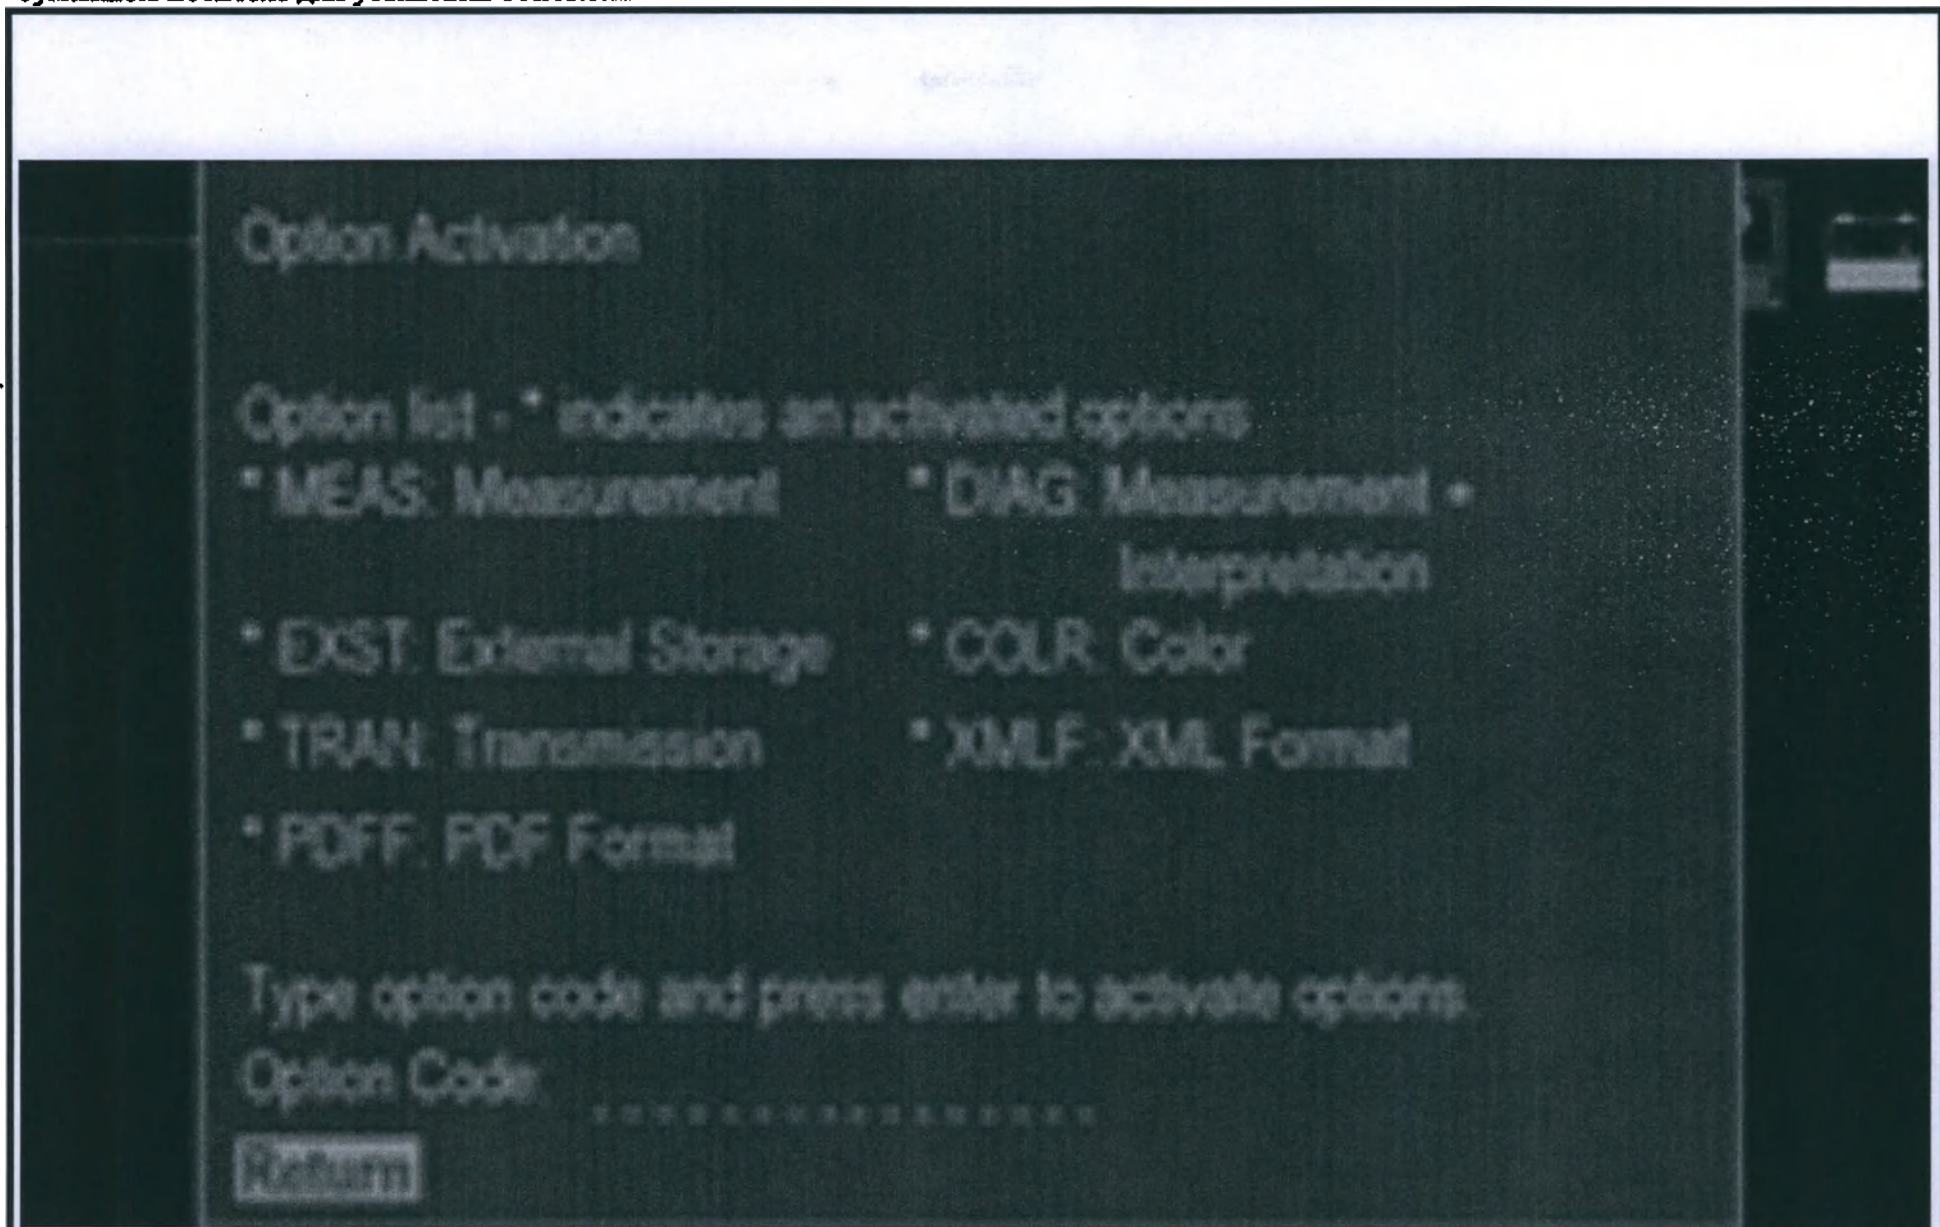


18. Программный ключ активации цветного дисплея на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.

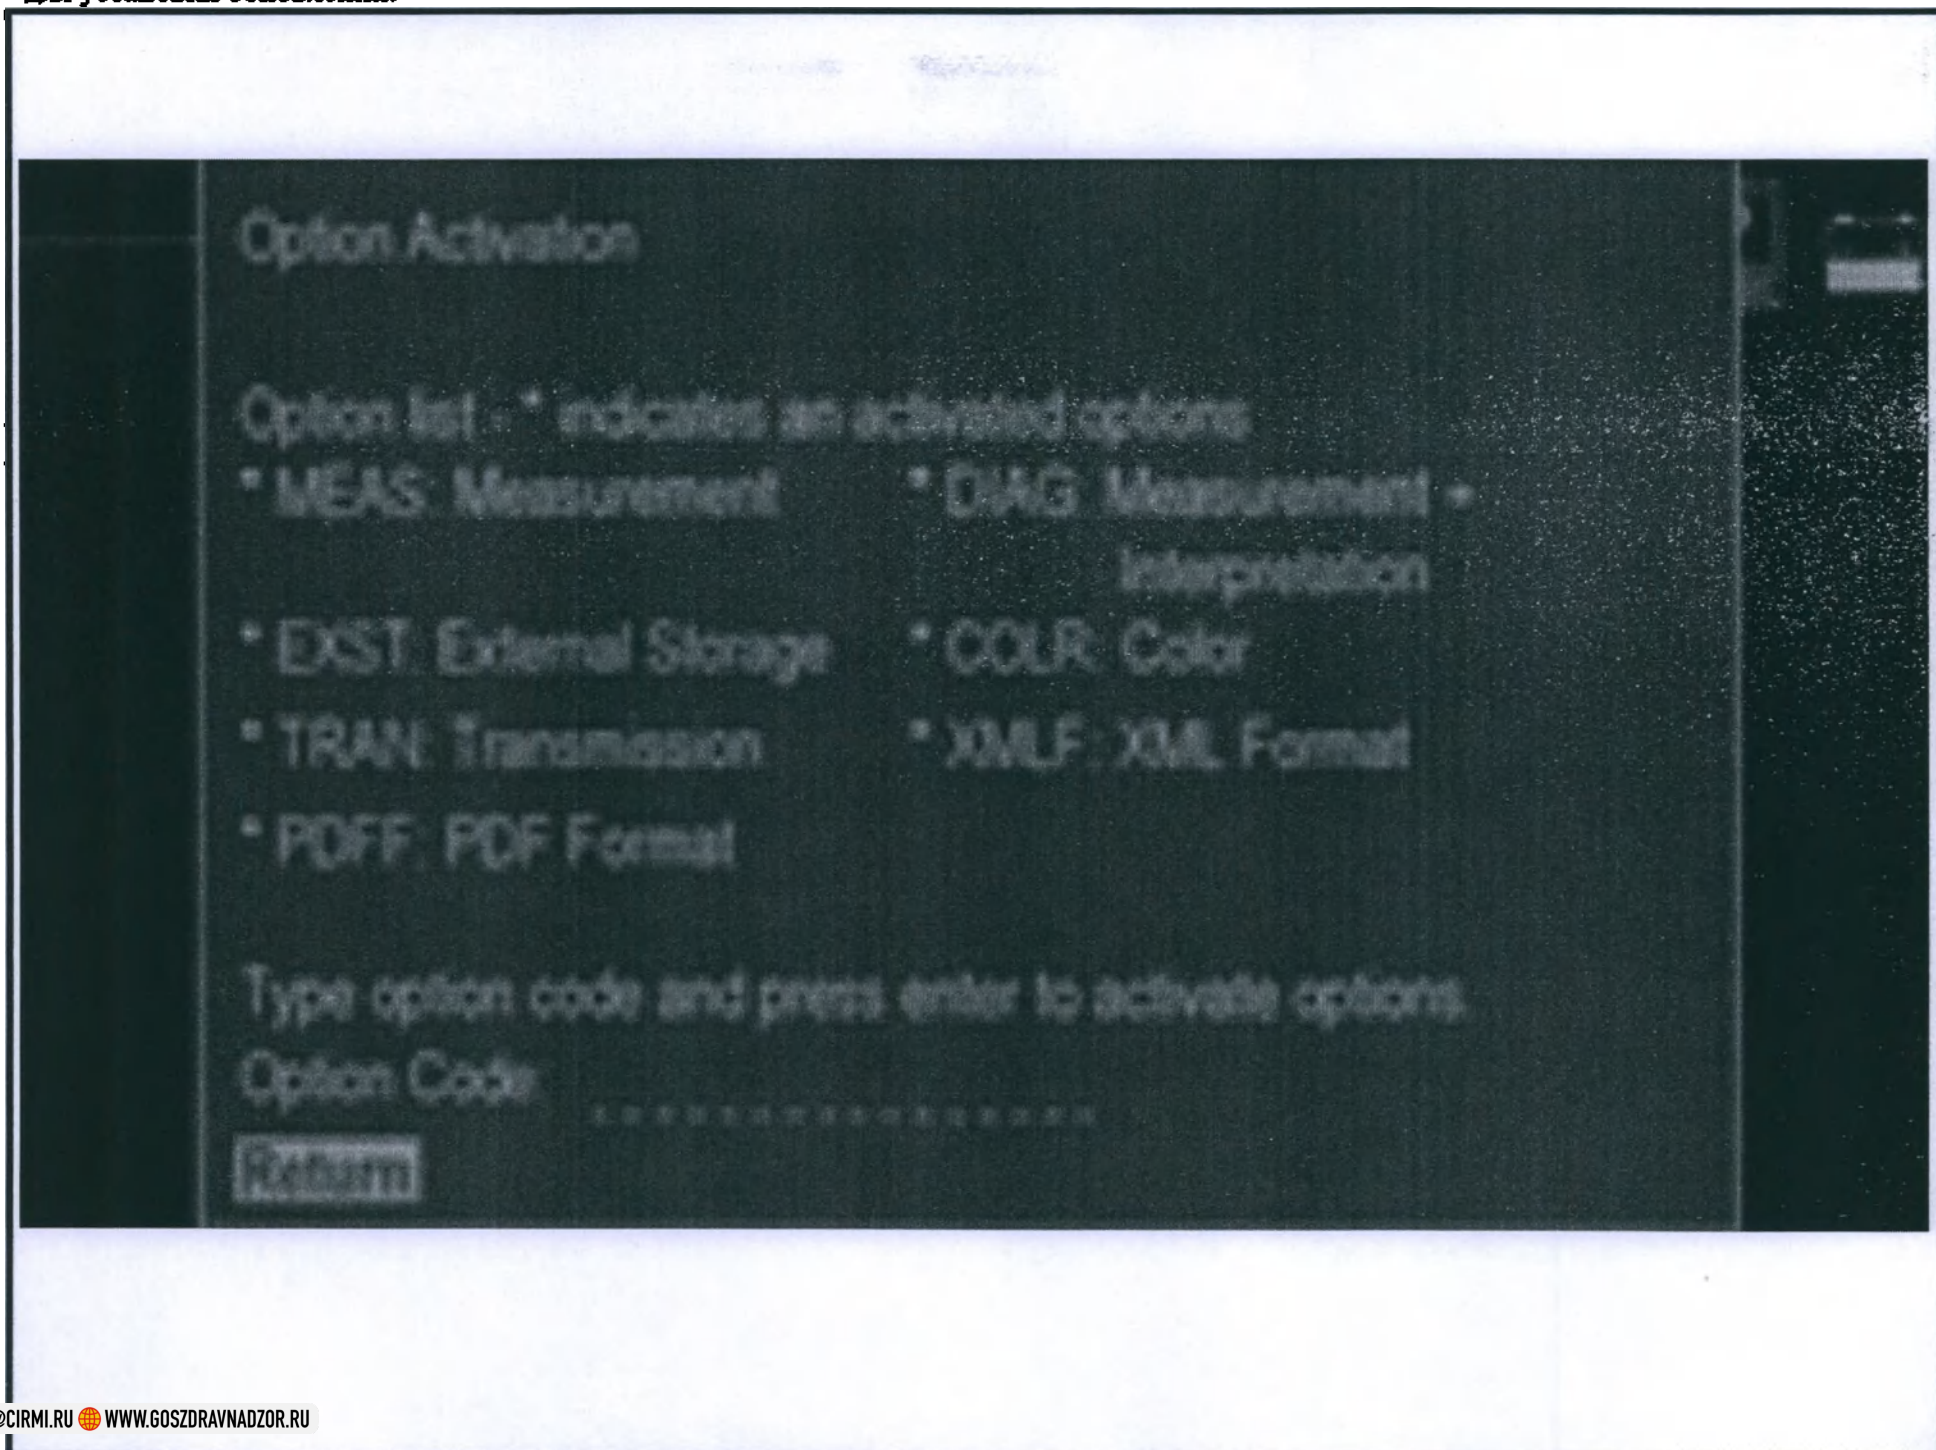


19. Программный ключ активации экспорта отчета в формате PDF на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.

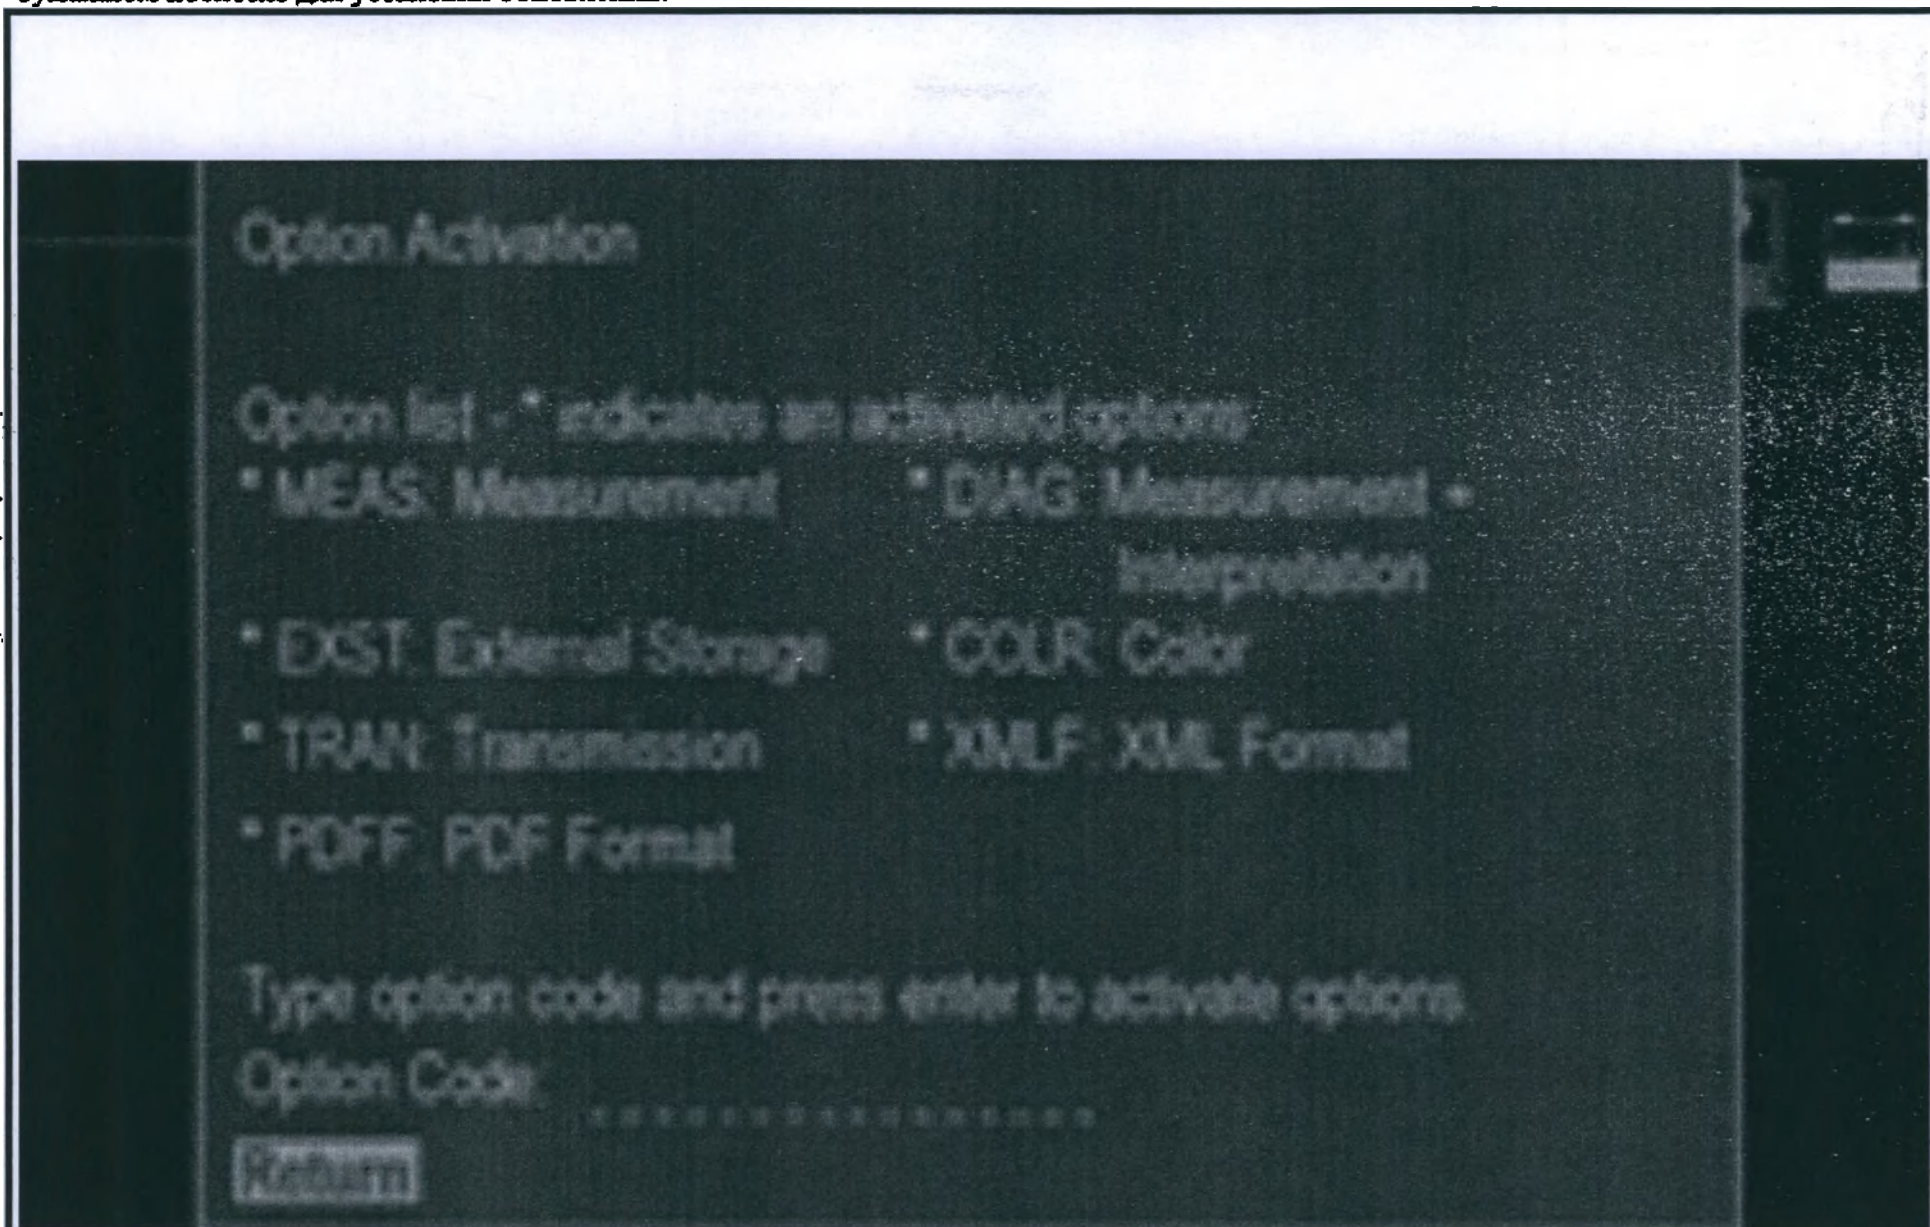


20. Программный ключ активации экспорта отчета в формате XML на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.

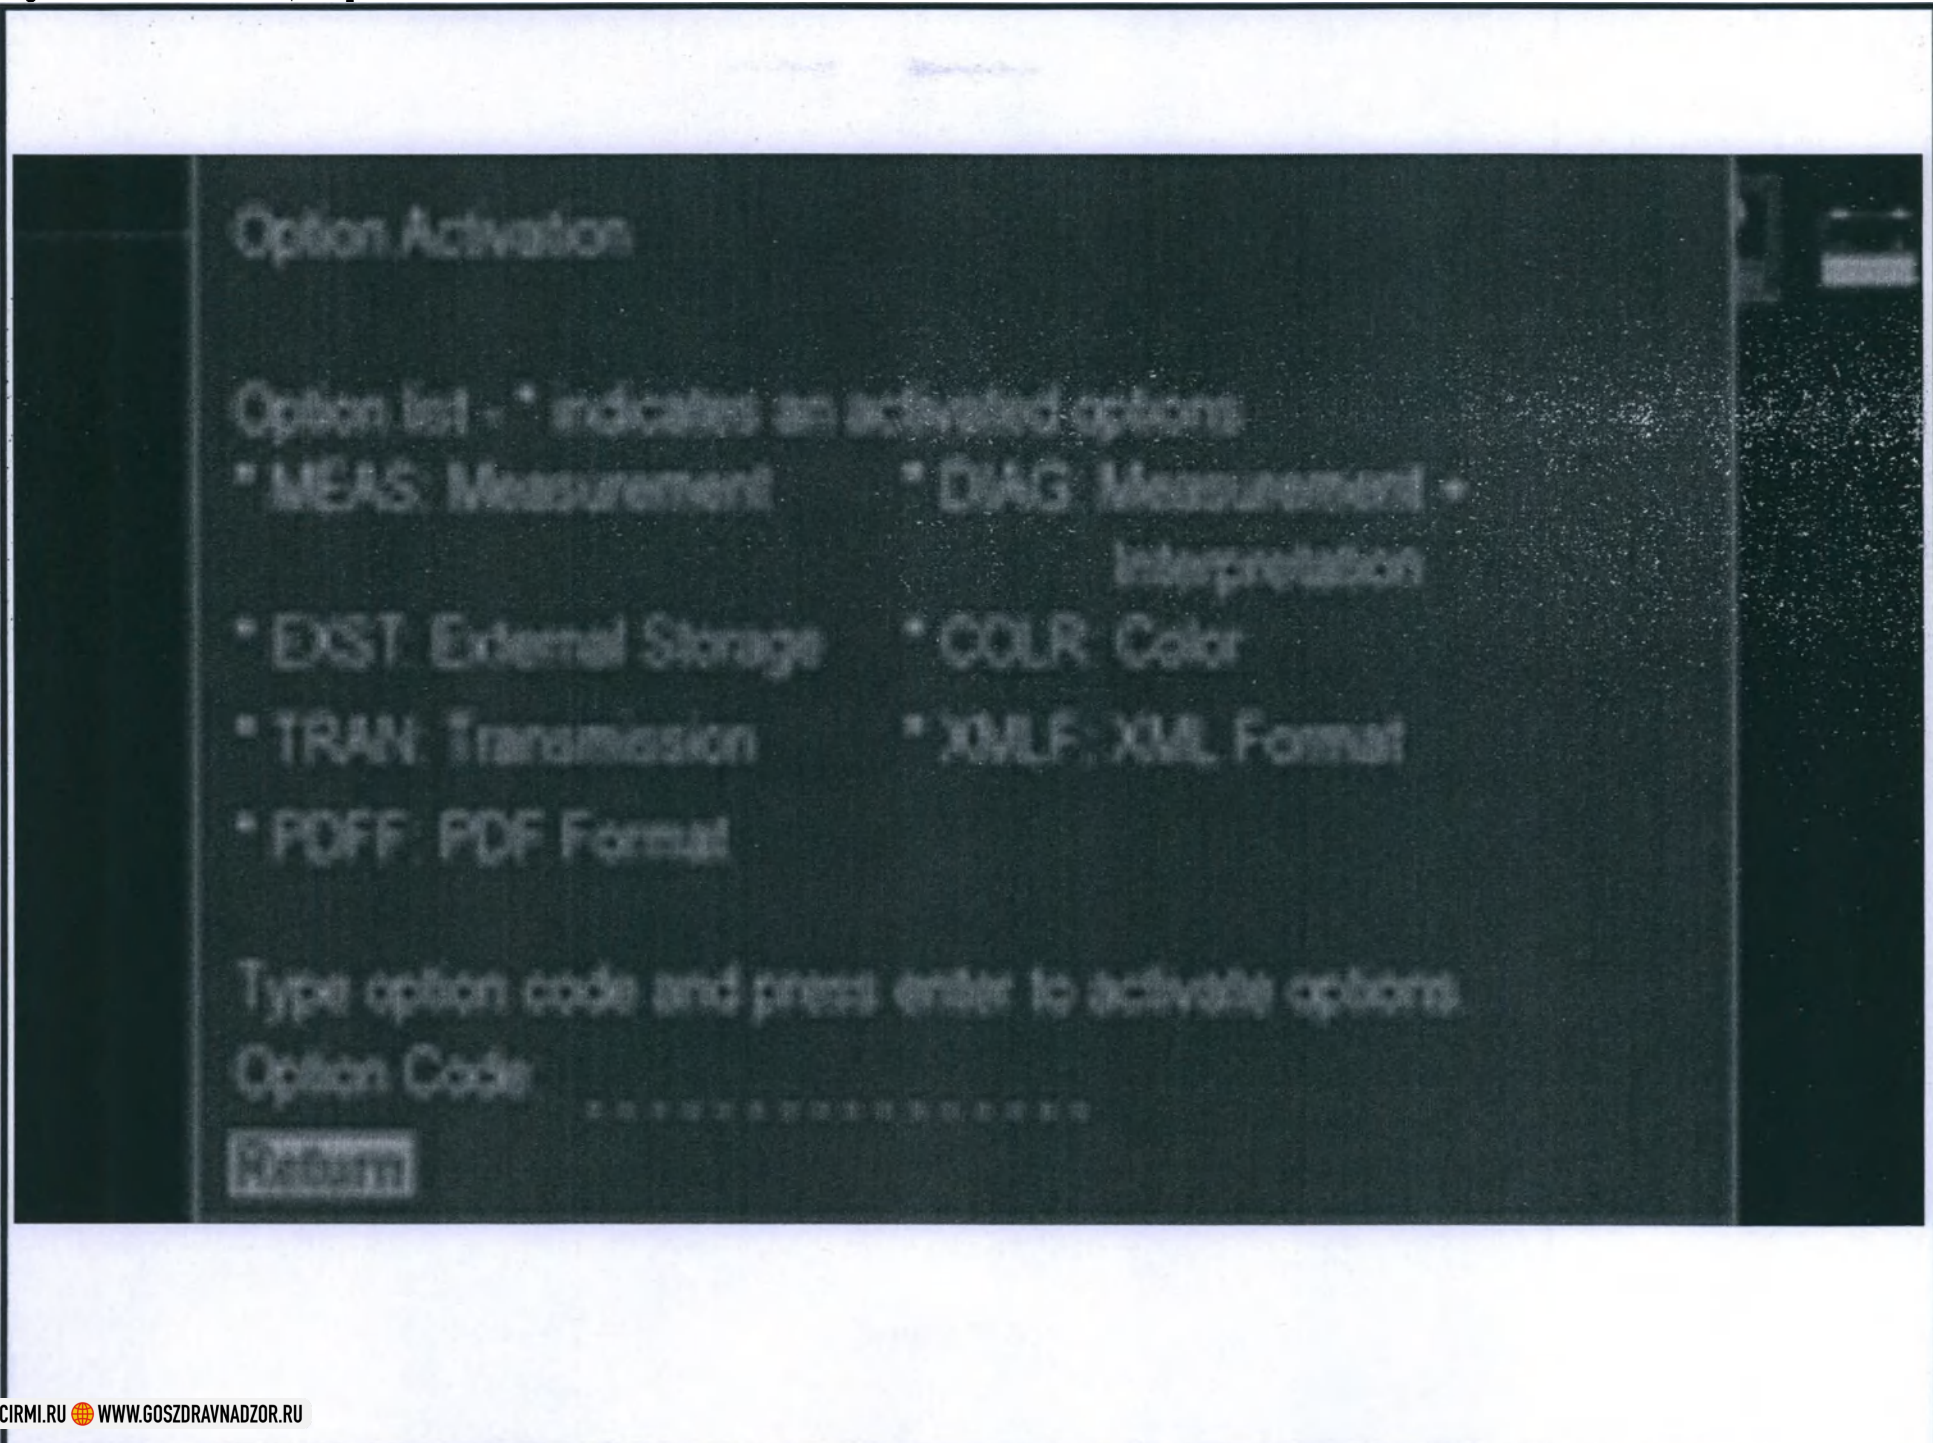


21. Программный ключ активации памяти для хранения ЭКГ на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.

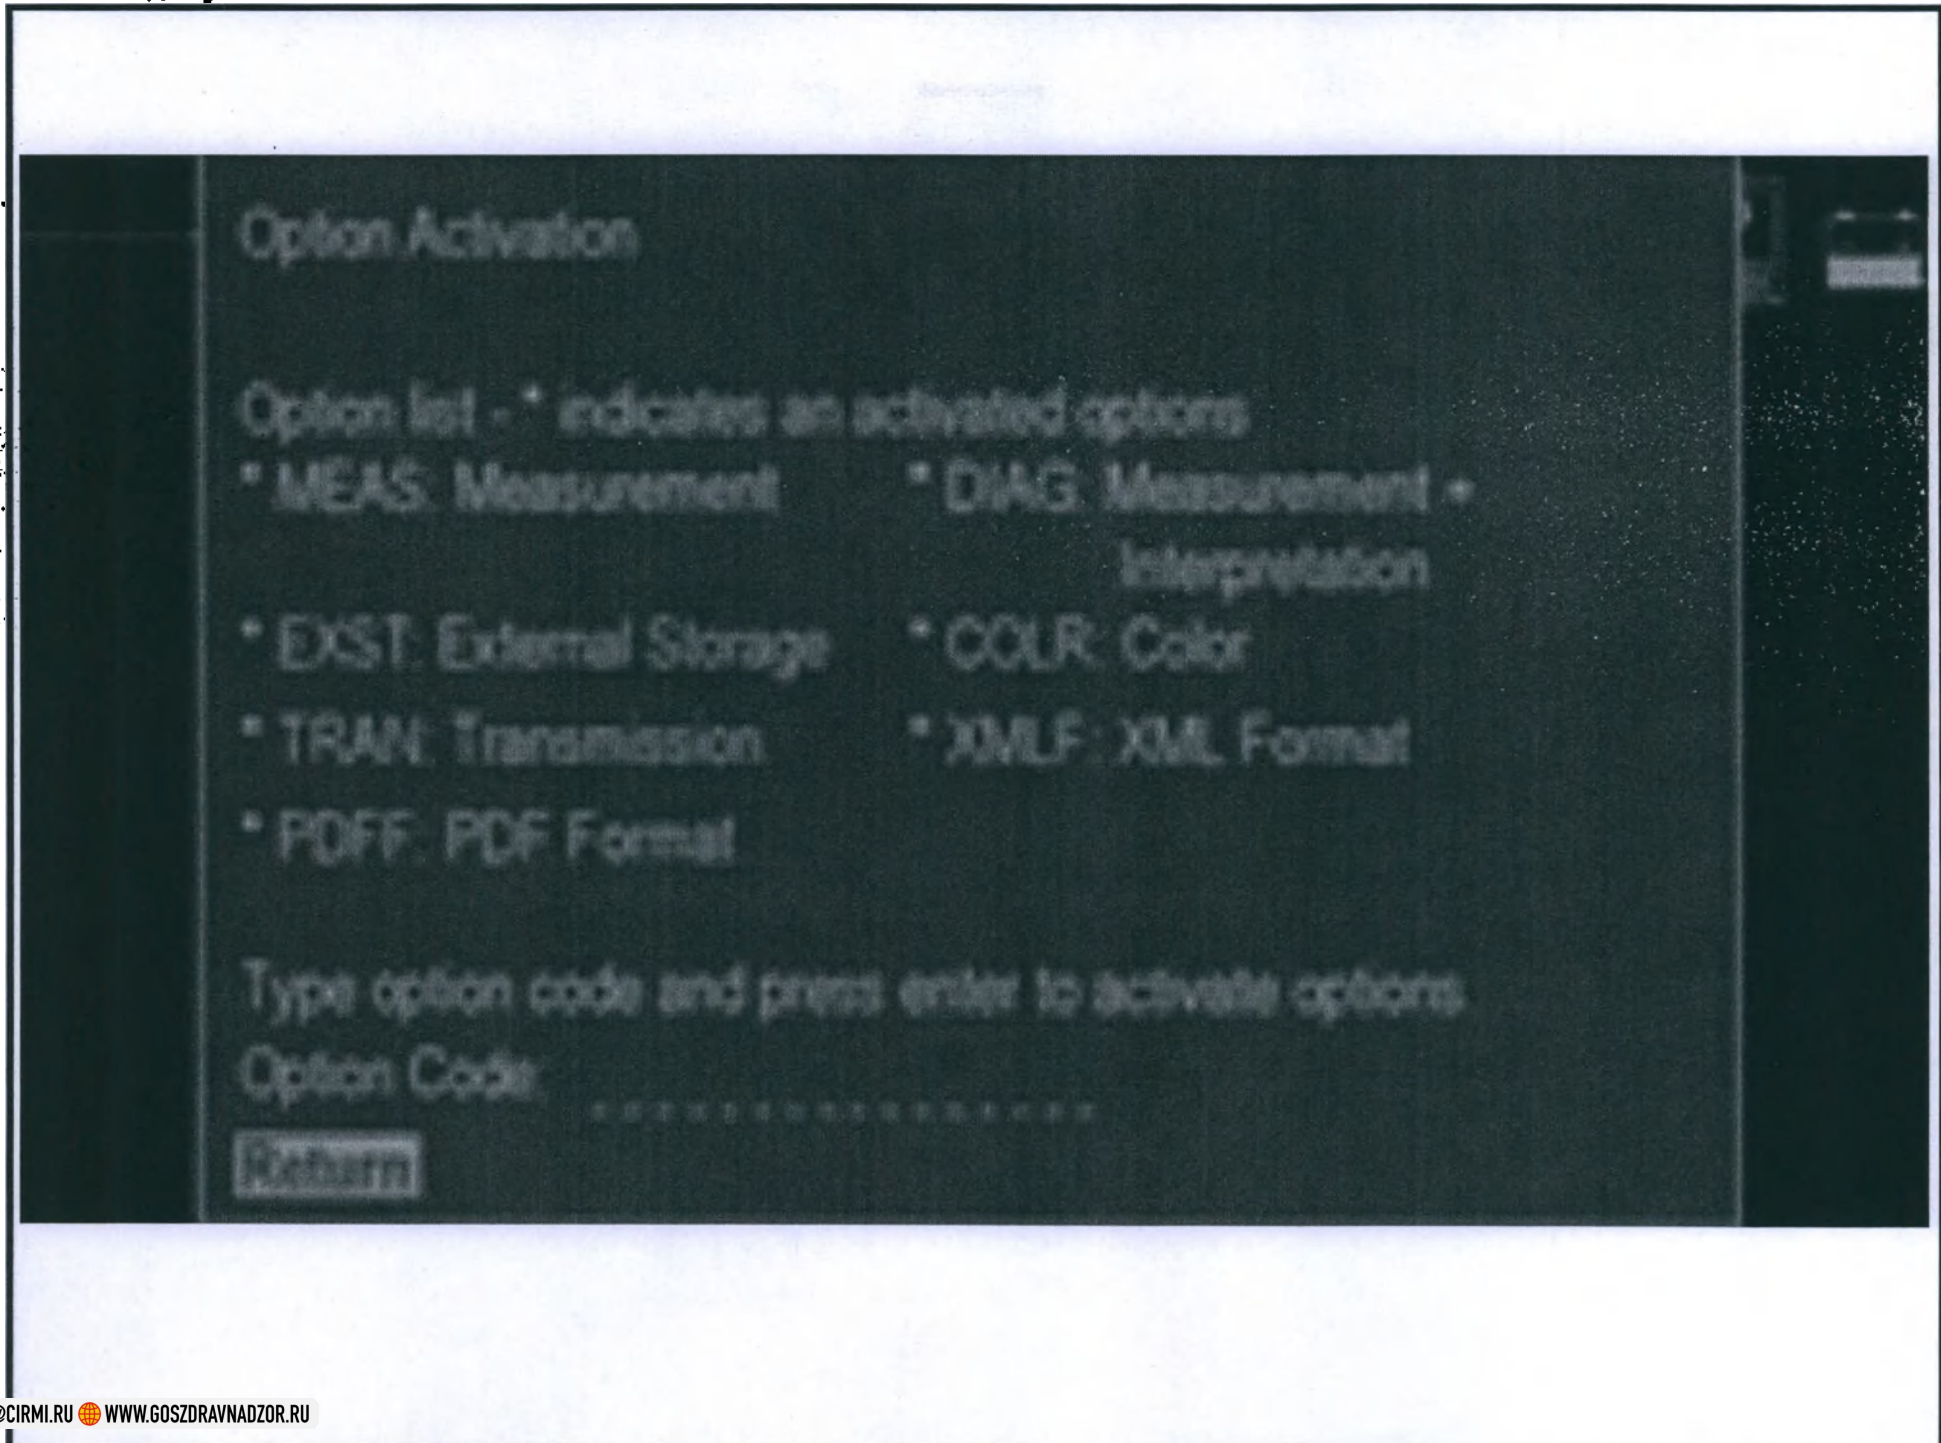


22. Программный ключ активации памяти для хранения ЭКГ и передачи данных в кардиологическое программное обеспечение на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.

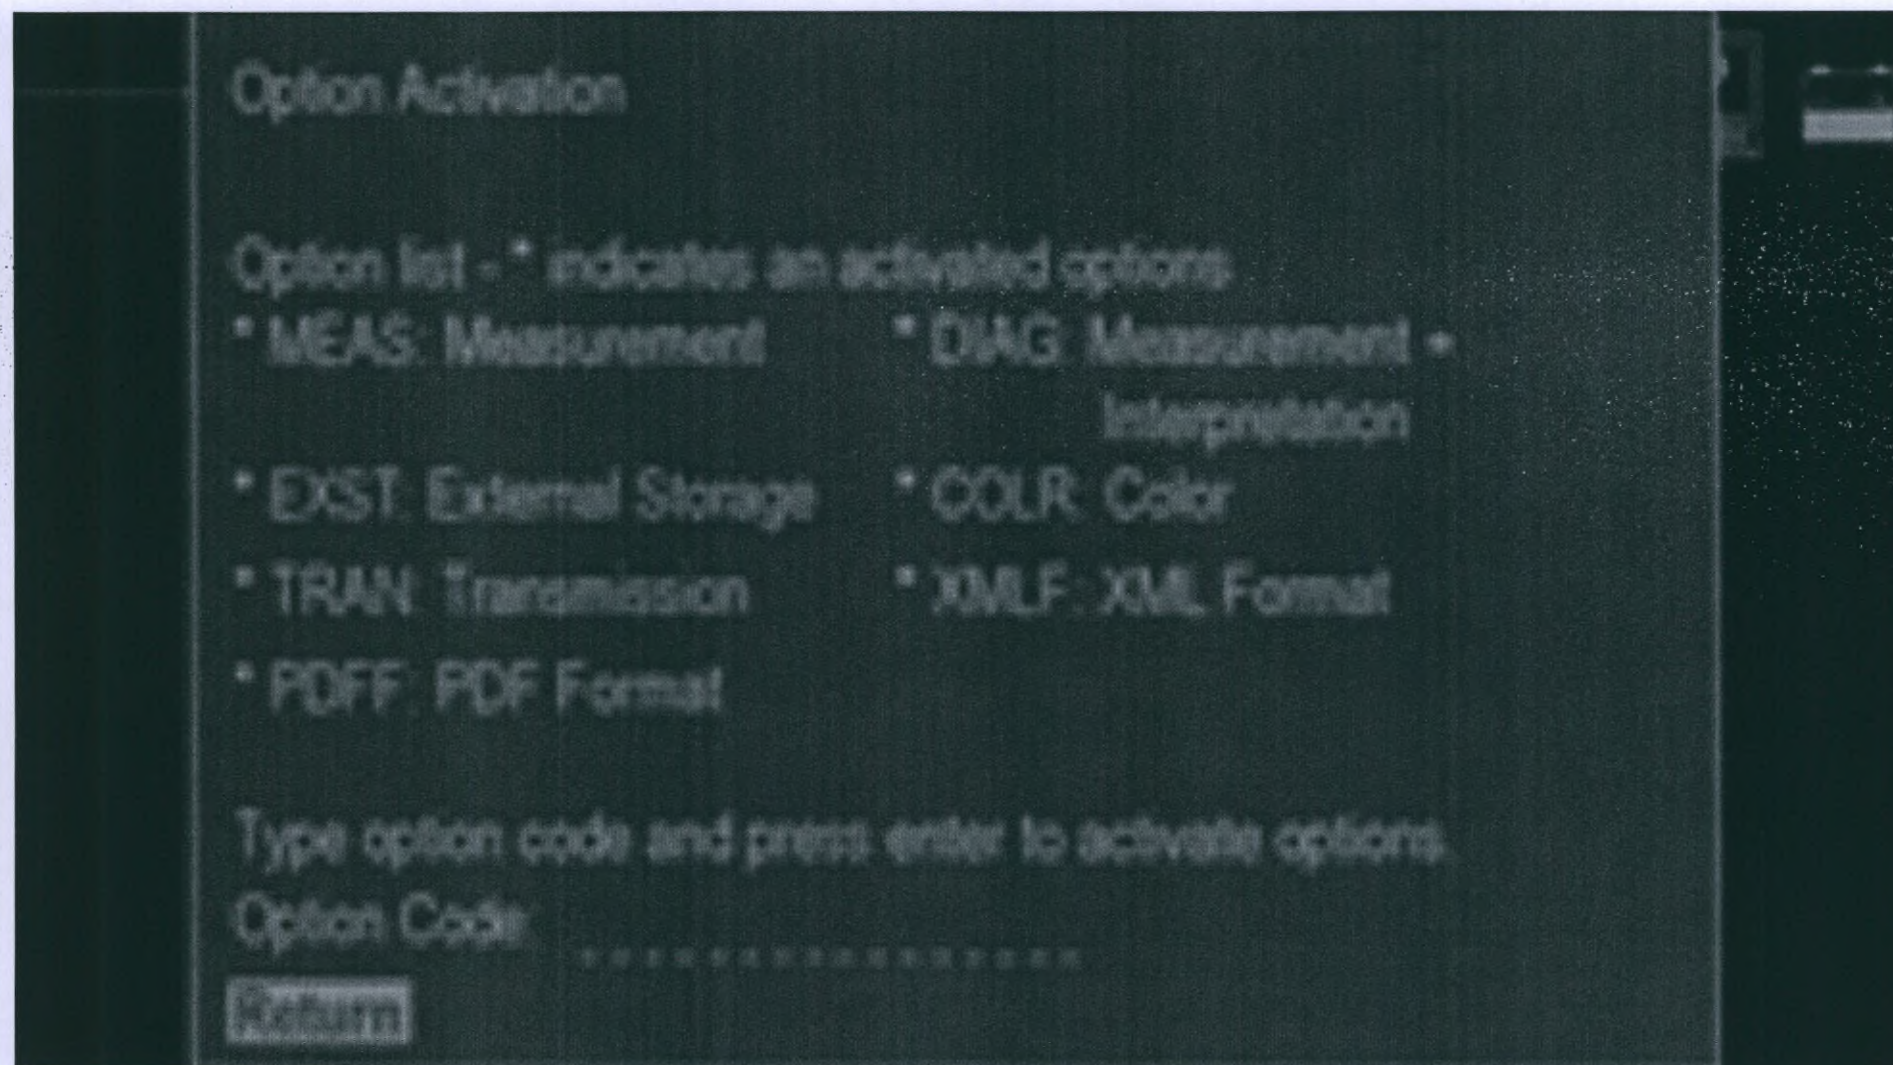


23. Программный ключ активации на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.

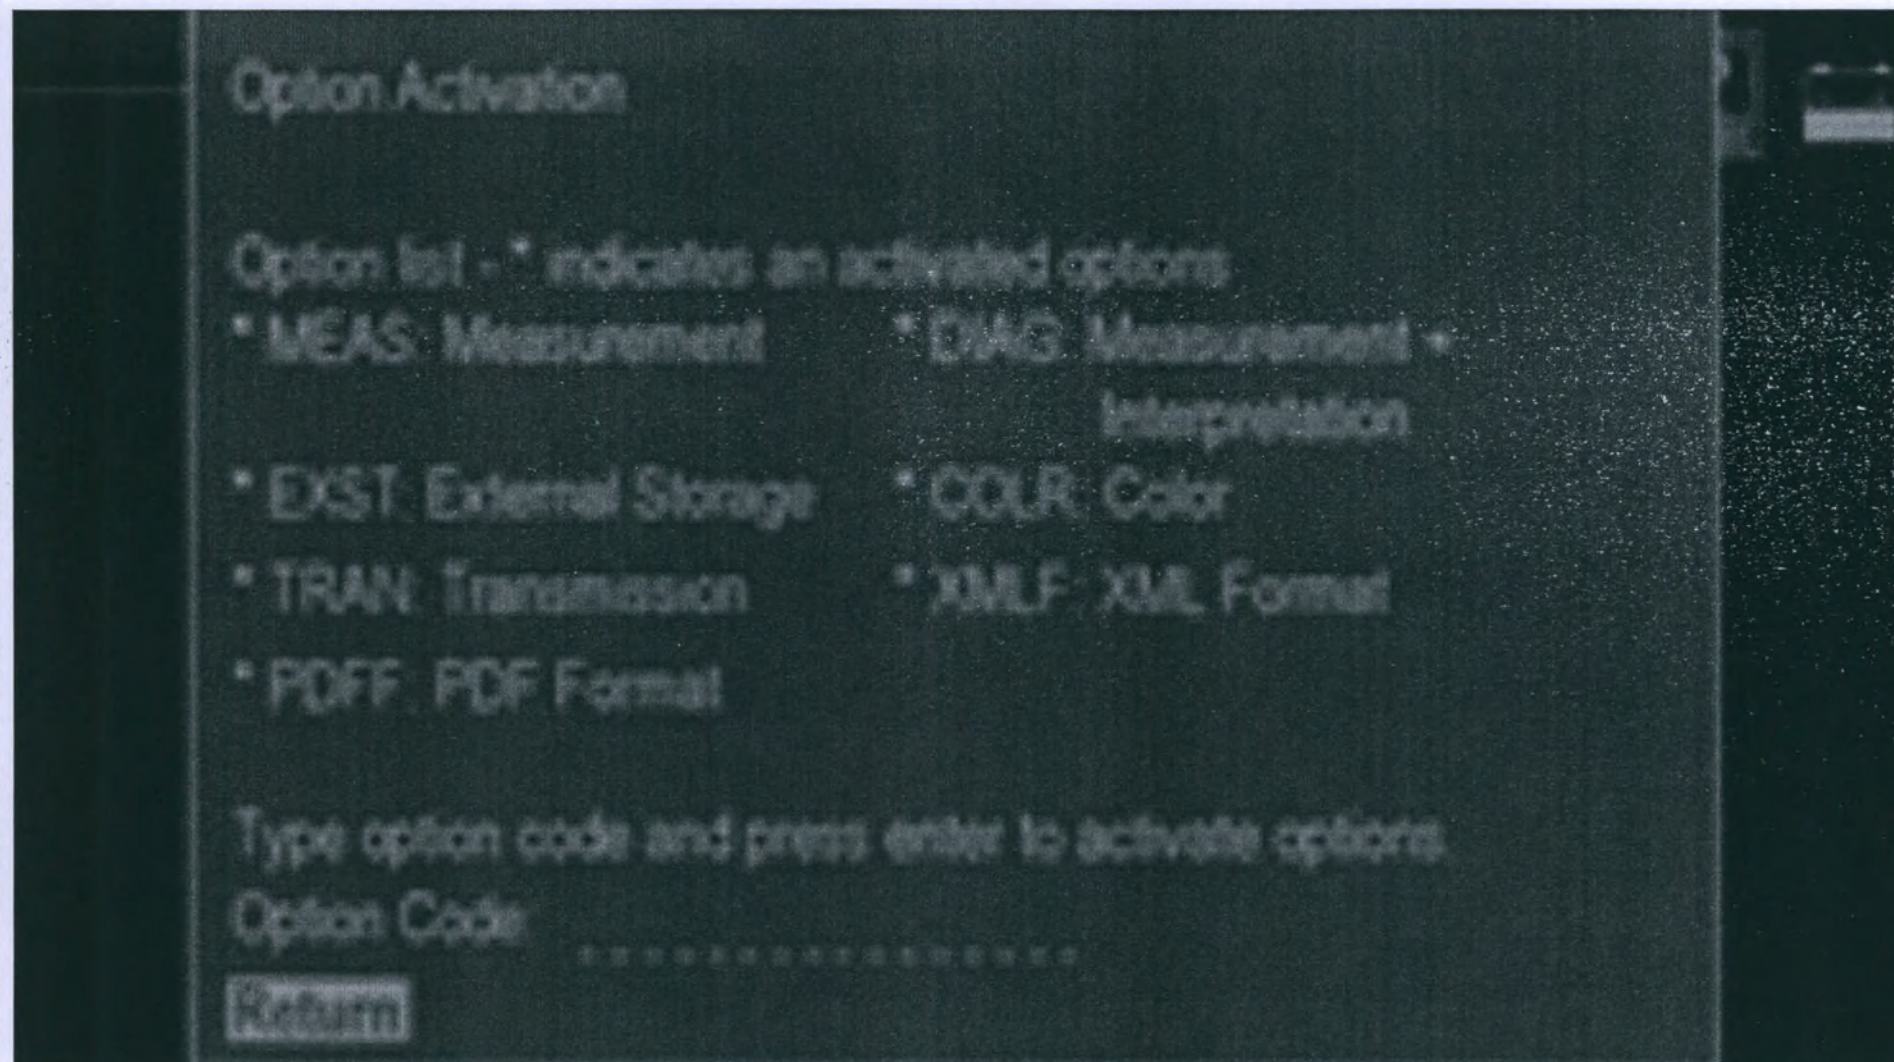


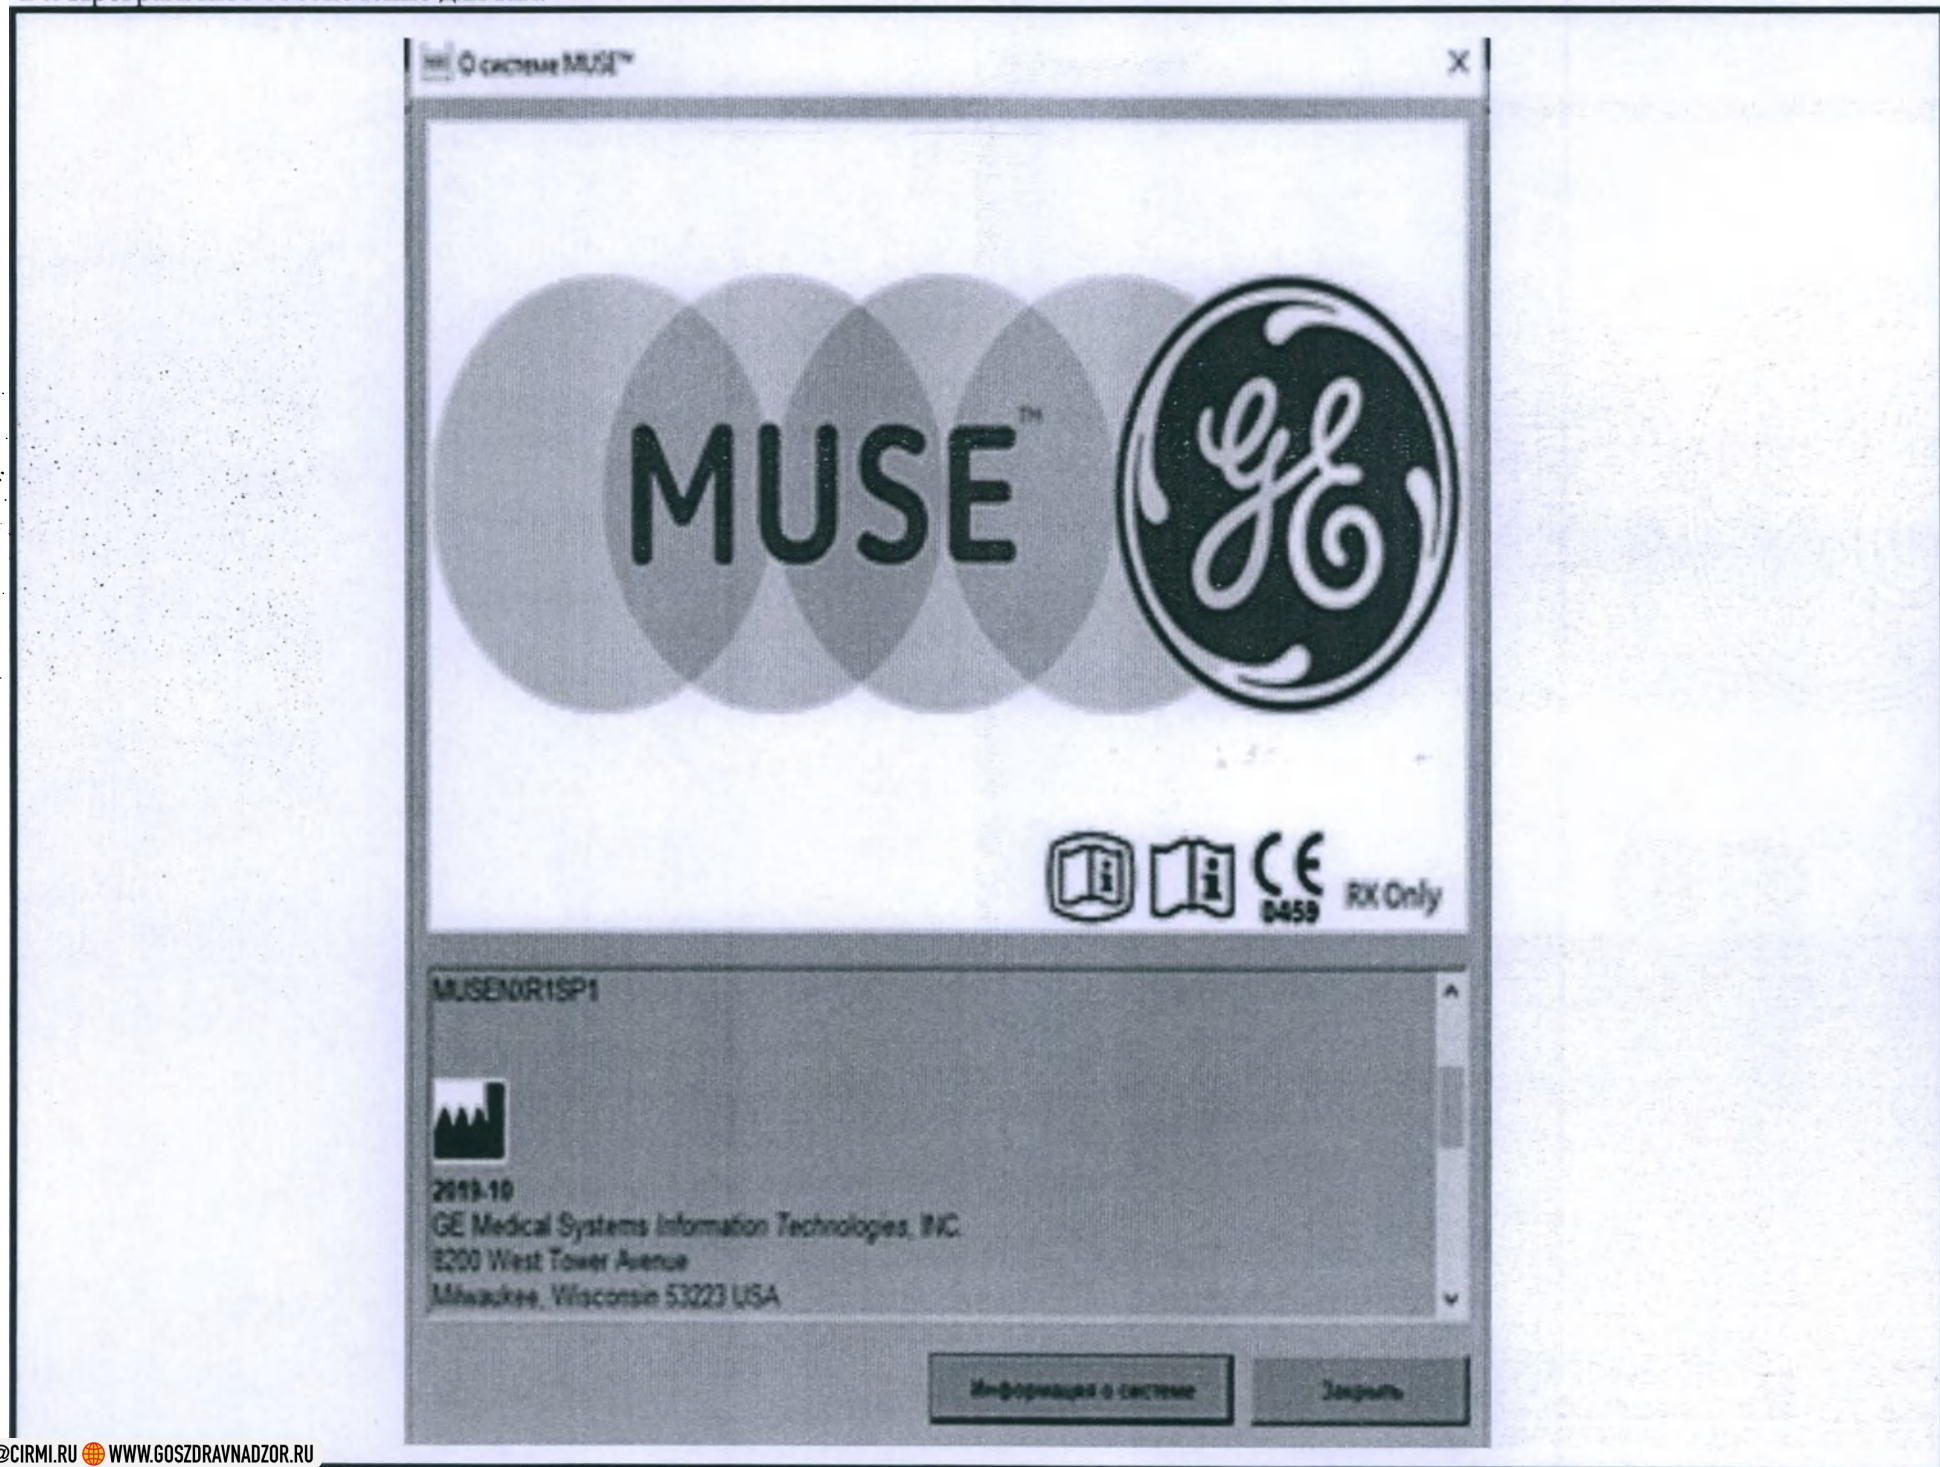


25. Программное обеспечение на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.

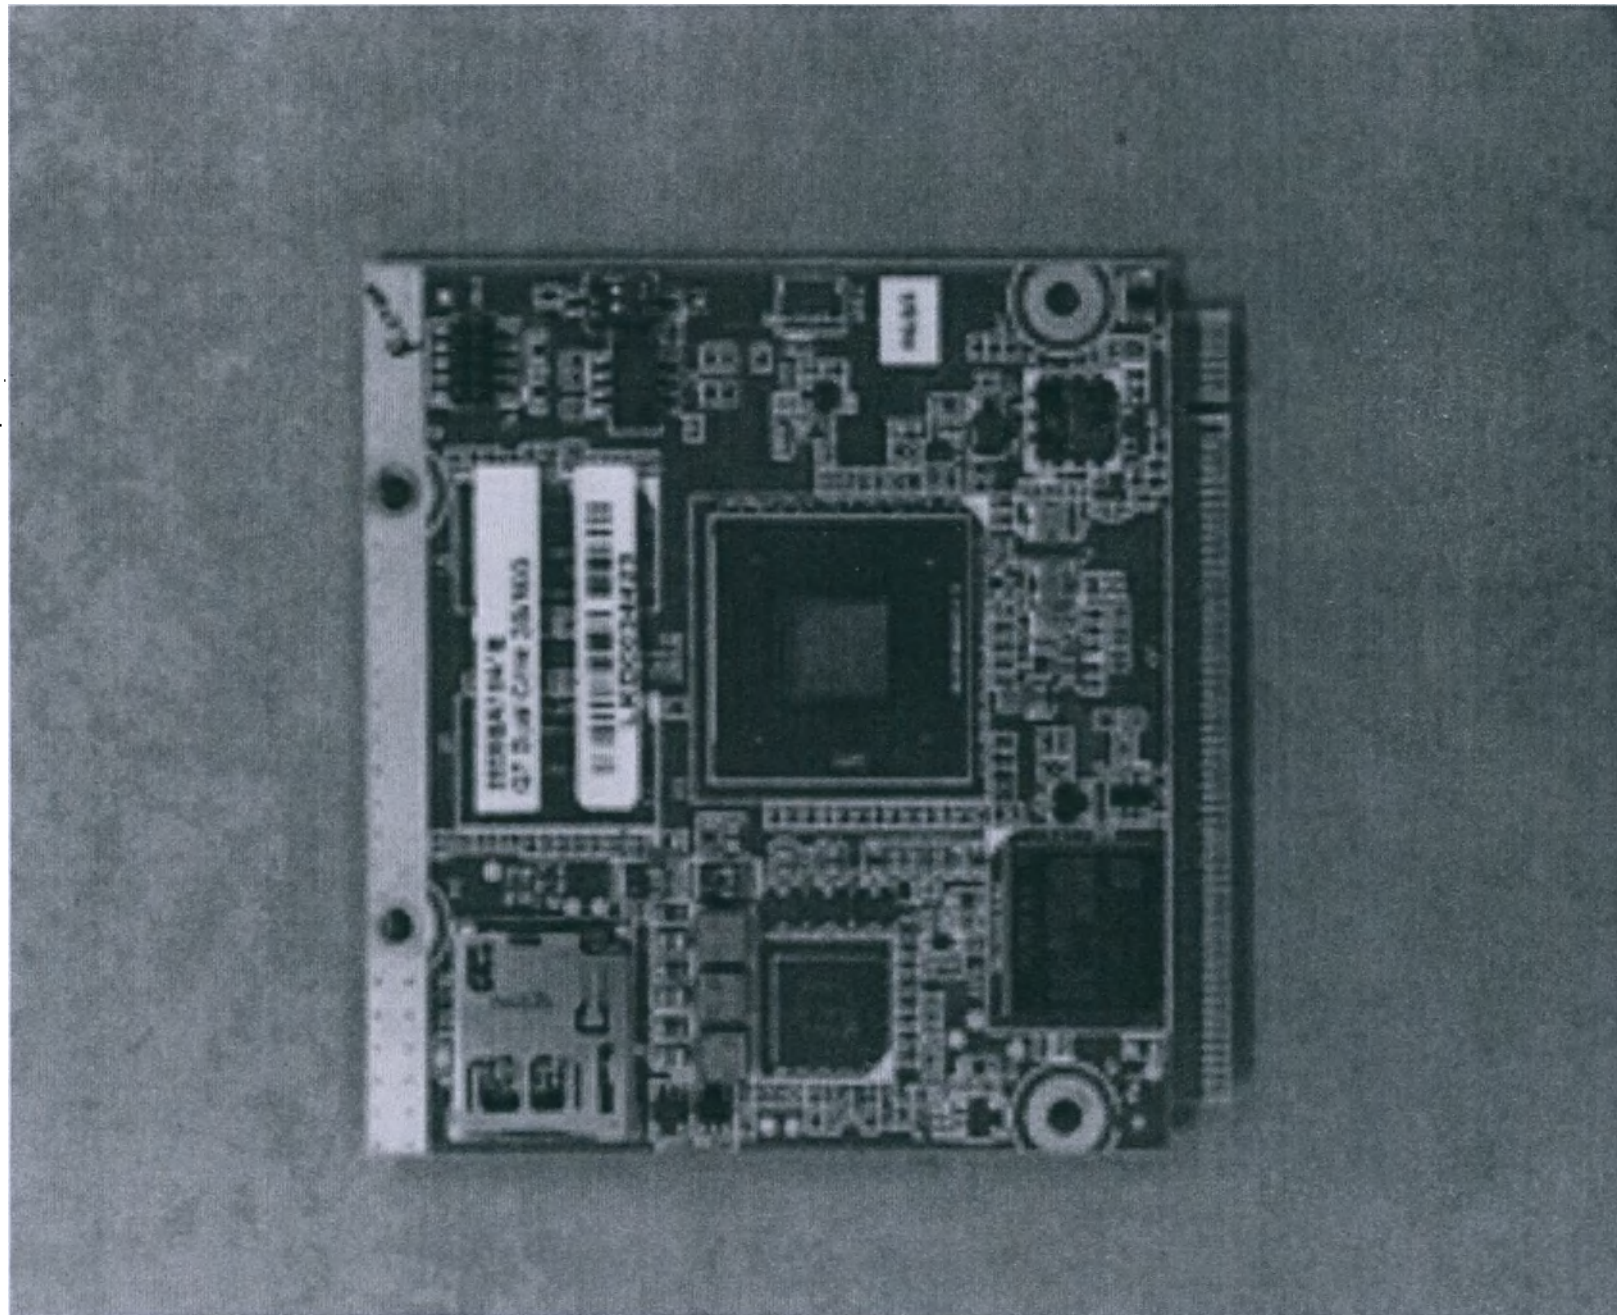


26. Терморегистратор, производитель GE Medical Systems Information Technologies, Inc., США.

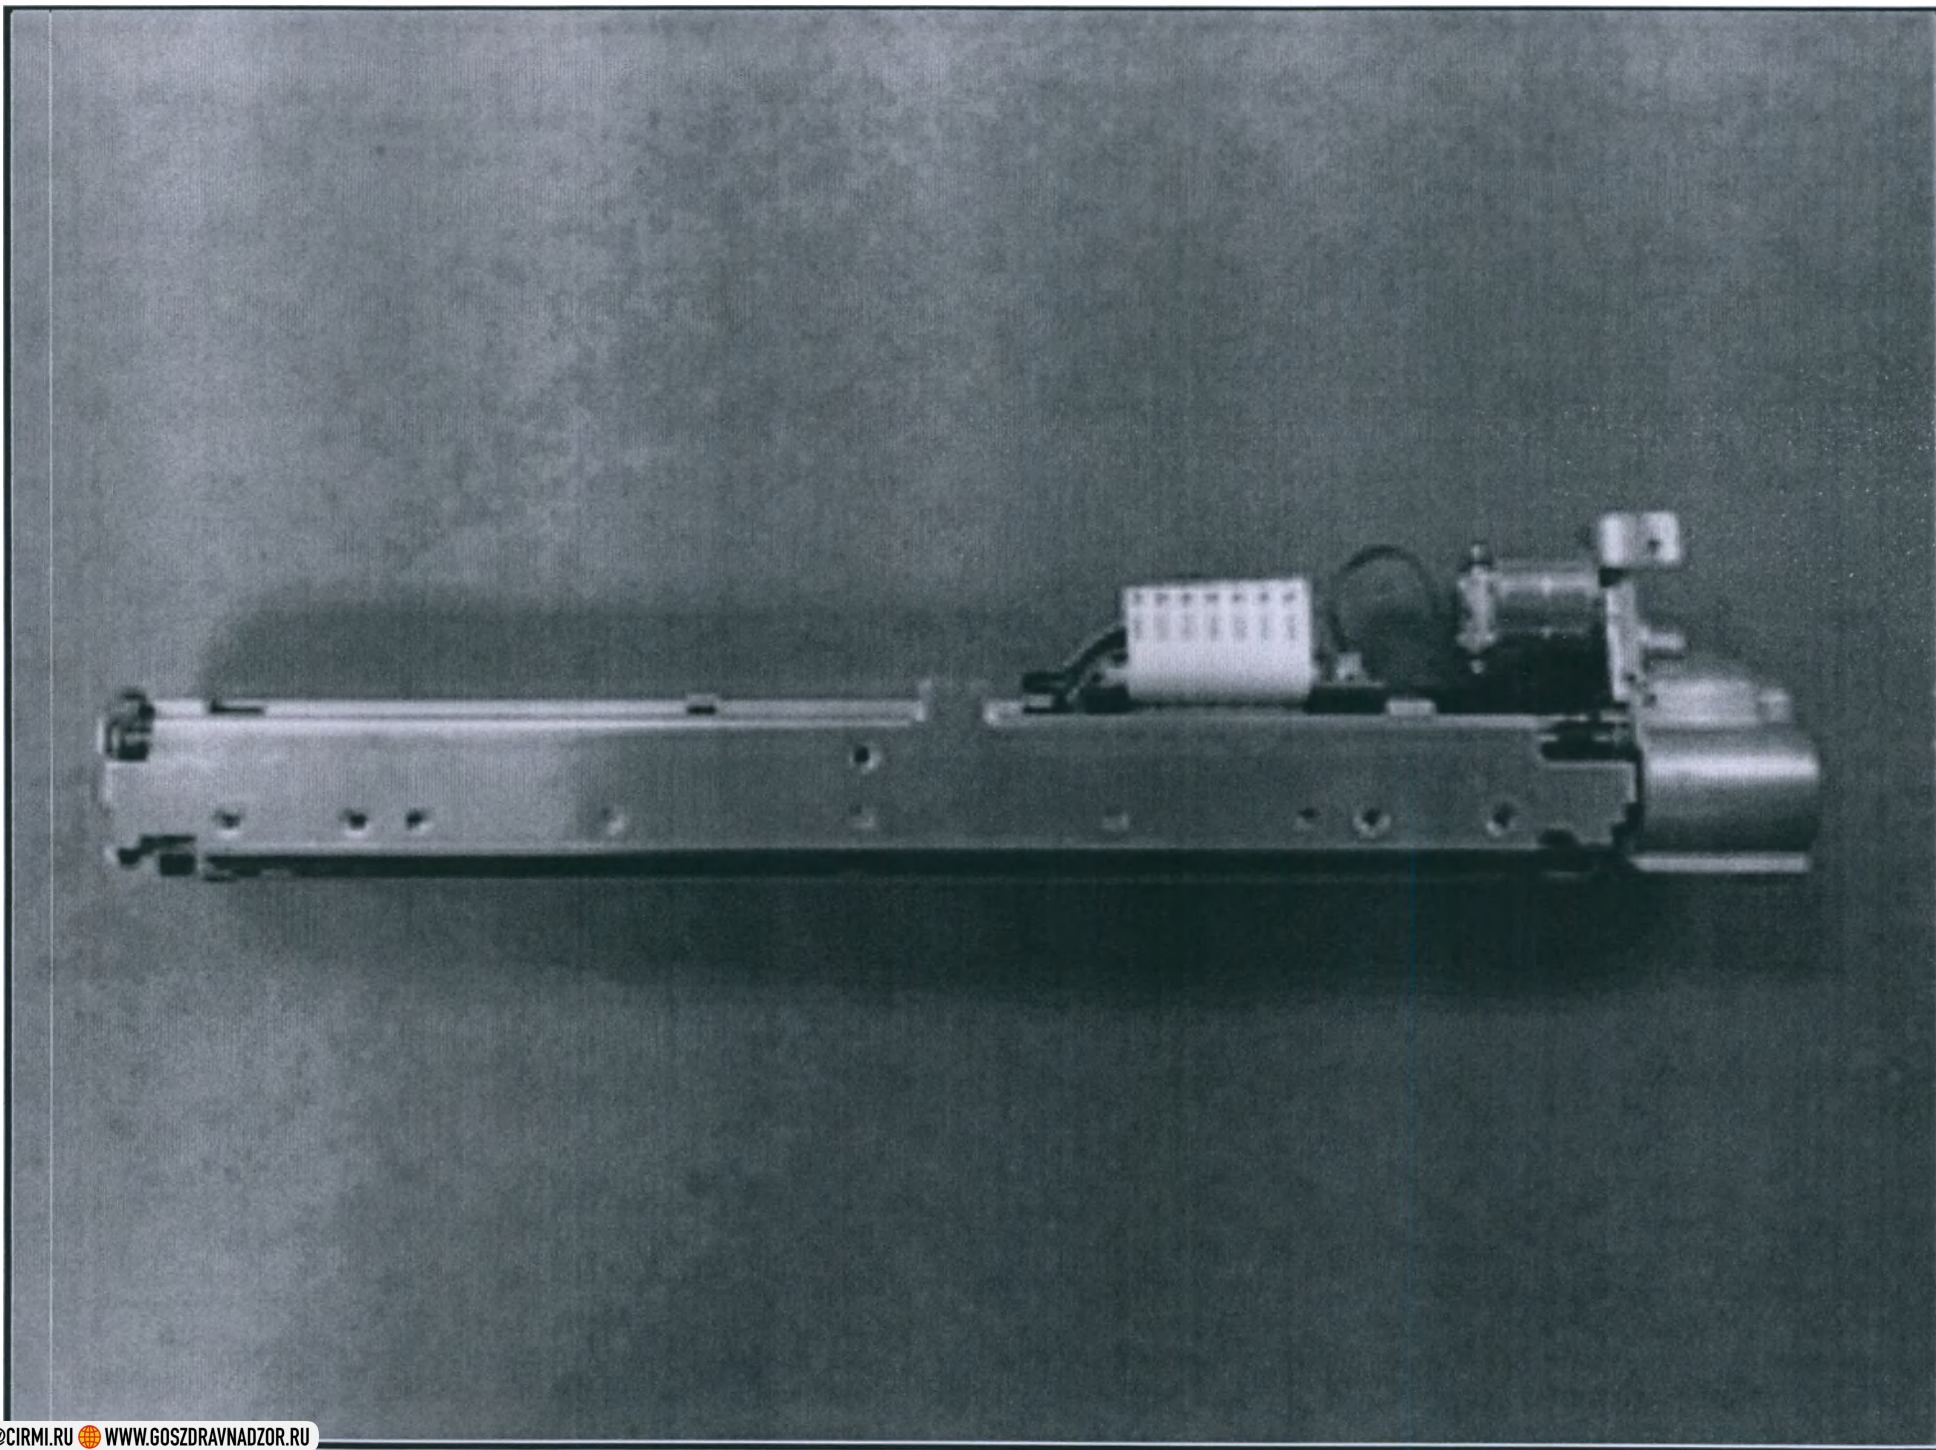

27. Устройство чтения карт памяти типа micro SD

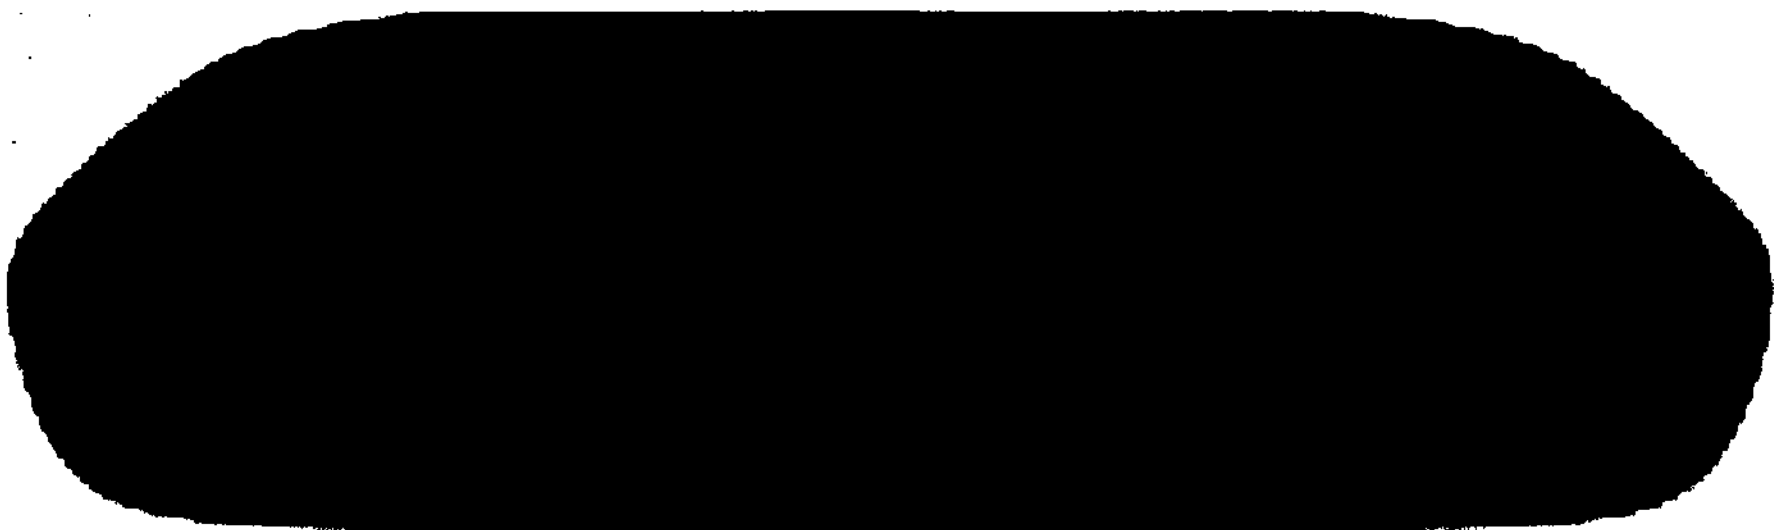


II. Электрокардиограф MAC 7: 1. Регистратор в сборе.

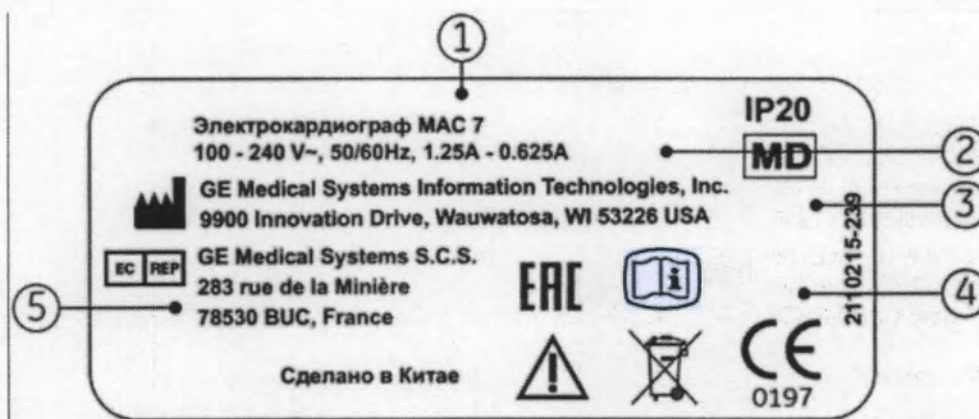

Элемент	Описание
1	Модель продукта
2	Расчетные электрические характеристики устройства
3	Наименование и адрес производителя
4	Символы (Описание символов представлены в таблице ниже)
5	Информация об уполномоченном европейском представителе

II. Электрокардиограф МАС 7: 1. Регистратор в сборе.

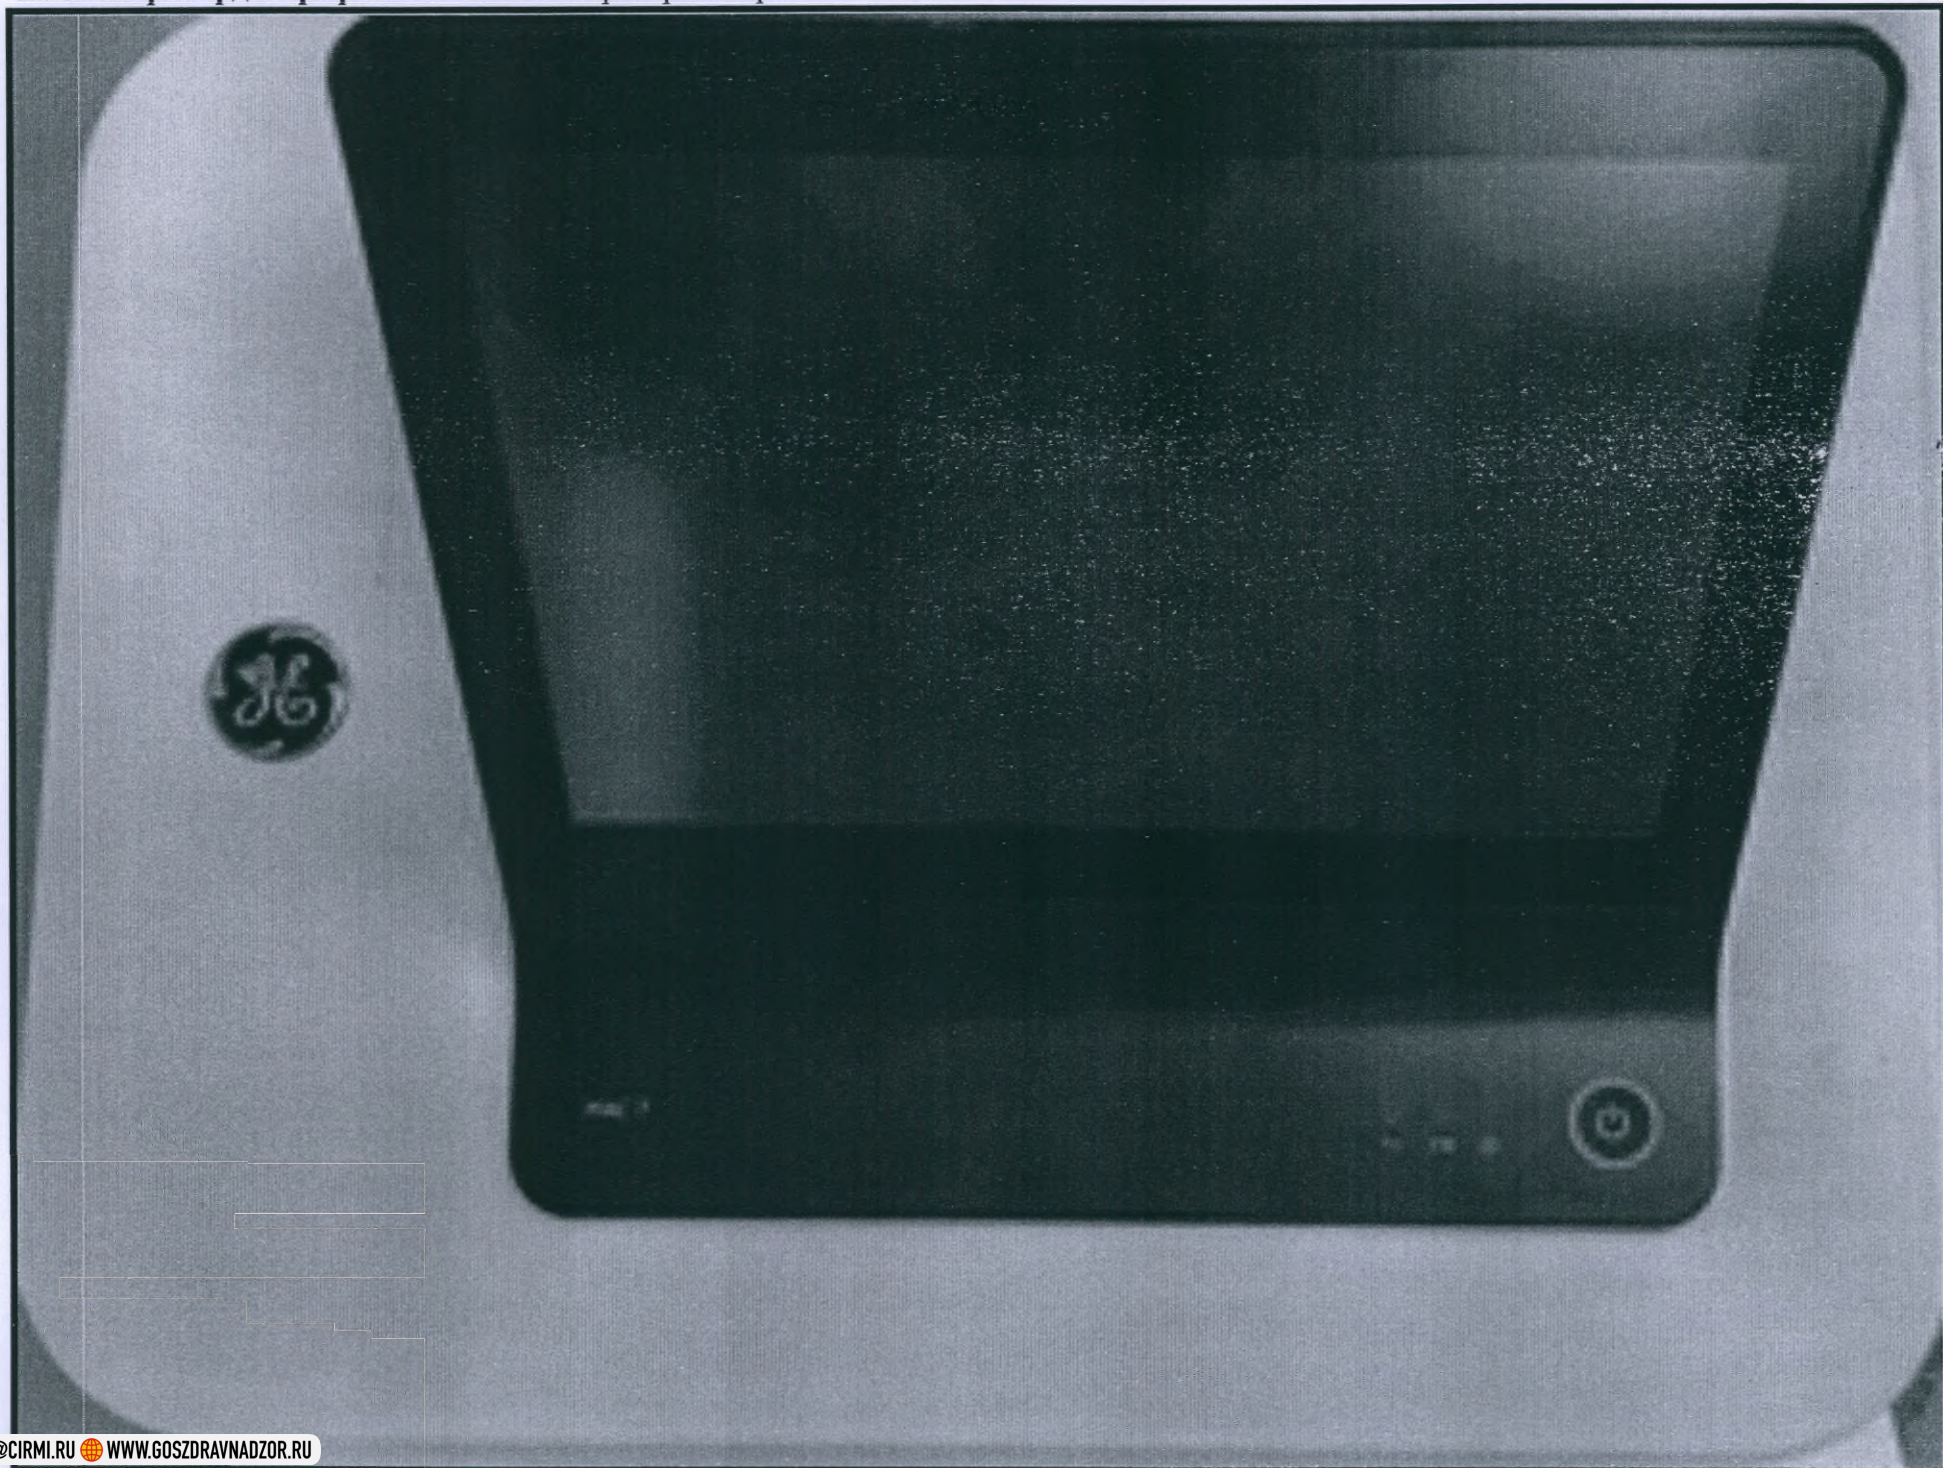

GE Healthcare

Электрокардиограф MAC в вариантах
исполнения

Электрокардиограф MAC 7

Руководство оператора

Версия 1


2109599-029-2

Постоянно храните данное руководство вместе
с руководством по эксплуатации прибора. Бере-
гите от влаги, пыли и повреждений.
Перед тем как просмотреть его,





Электрокардиограф MAC 7
Руководство оператора
Russian
© 2013 General Electric Company
Все права защищены.

3. Шнур питания евростандарт.

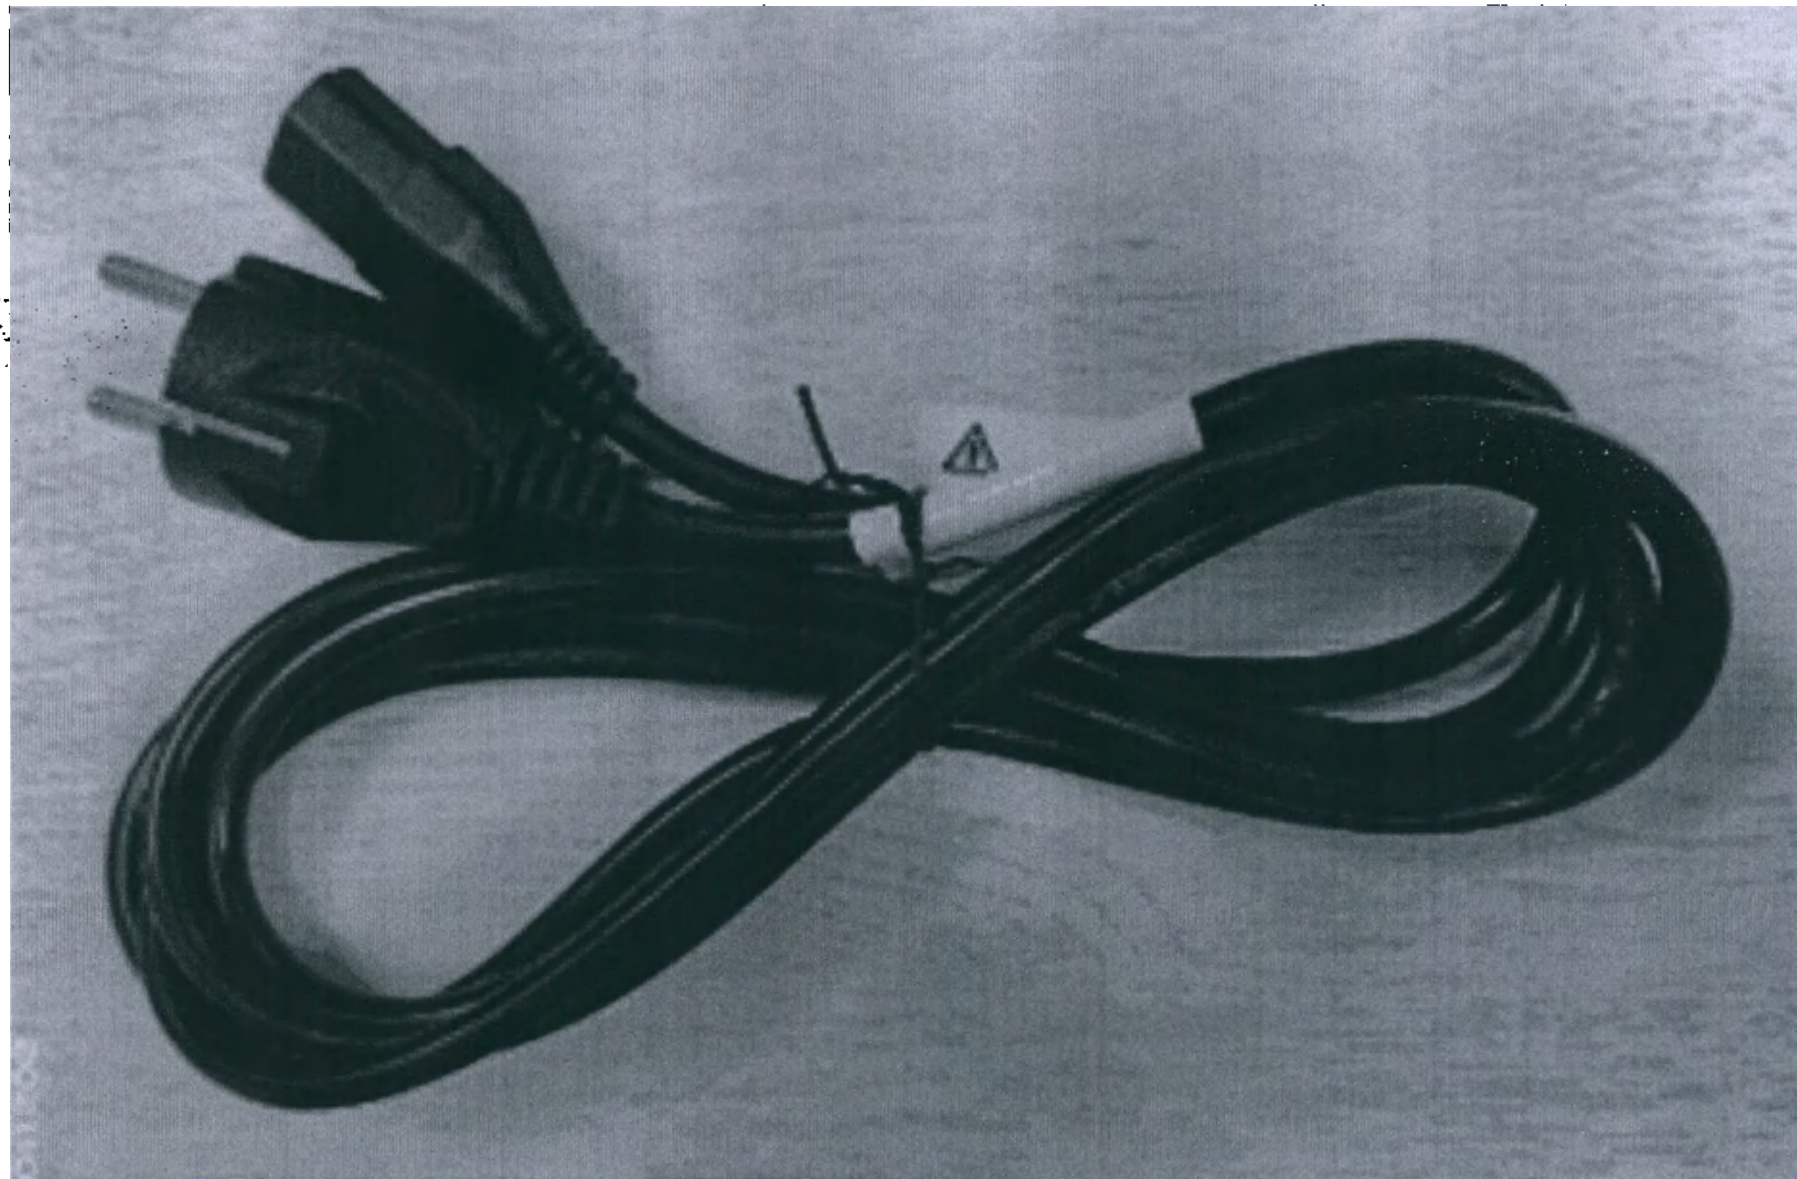


4. Спреи электродные во флаконе не менее 200 мл (не более 50 шт.), производитель GE Medical Systems Information Technologies, Inc., США (при необходимости).

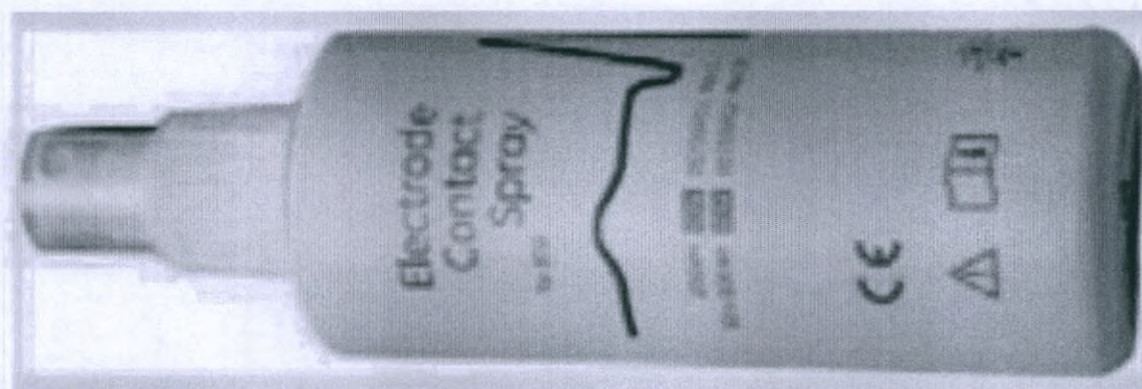


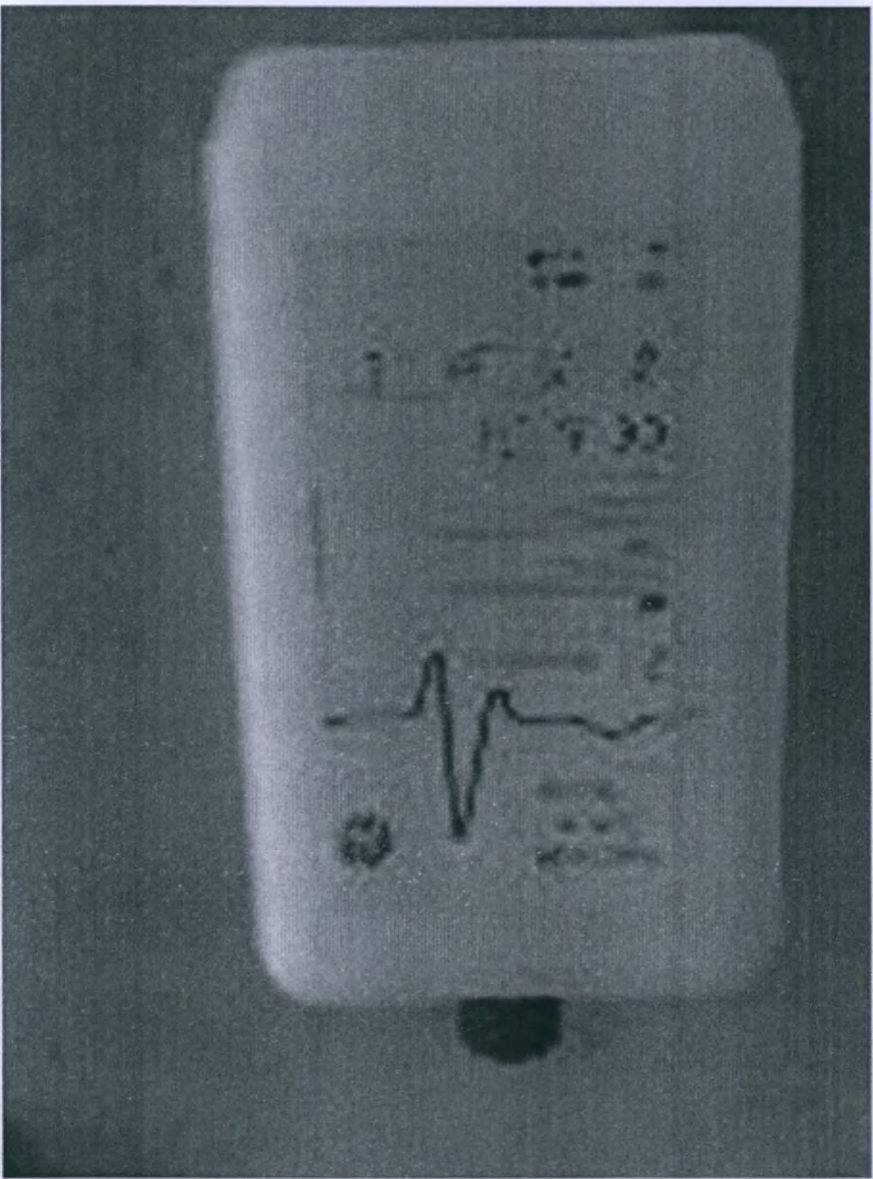

5. Спрей электродный контактный в канистре (не более 5 шт.) (при необходимости).


6. Кабели пациента интегрированные, ИЕС (не более 50 шт.) (при необходимости).

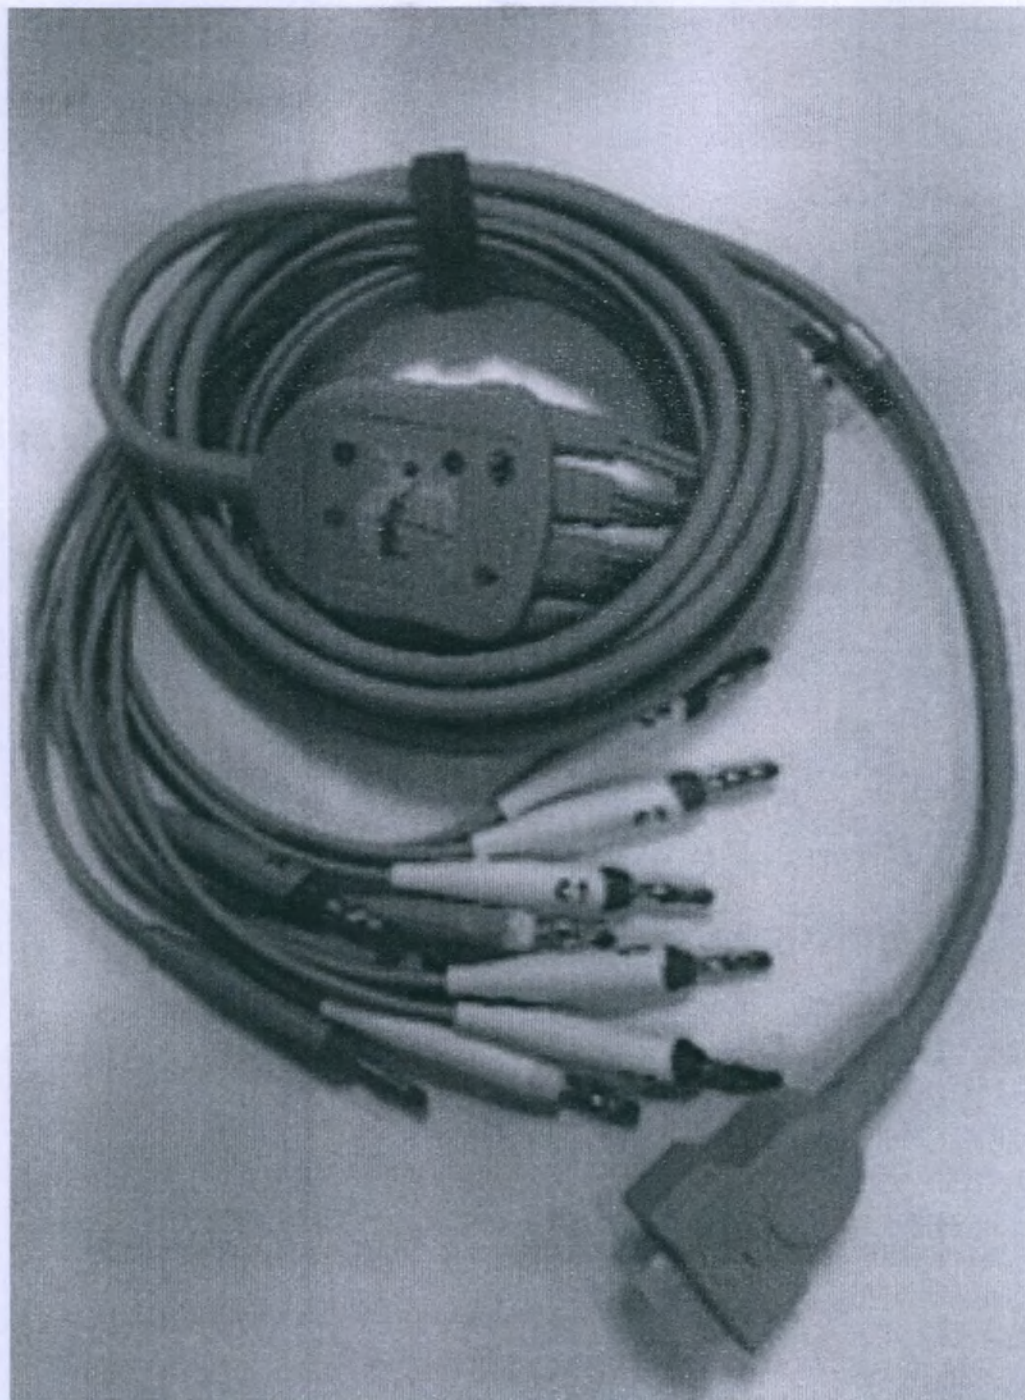

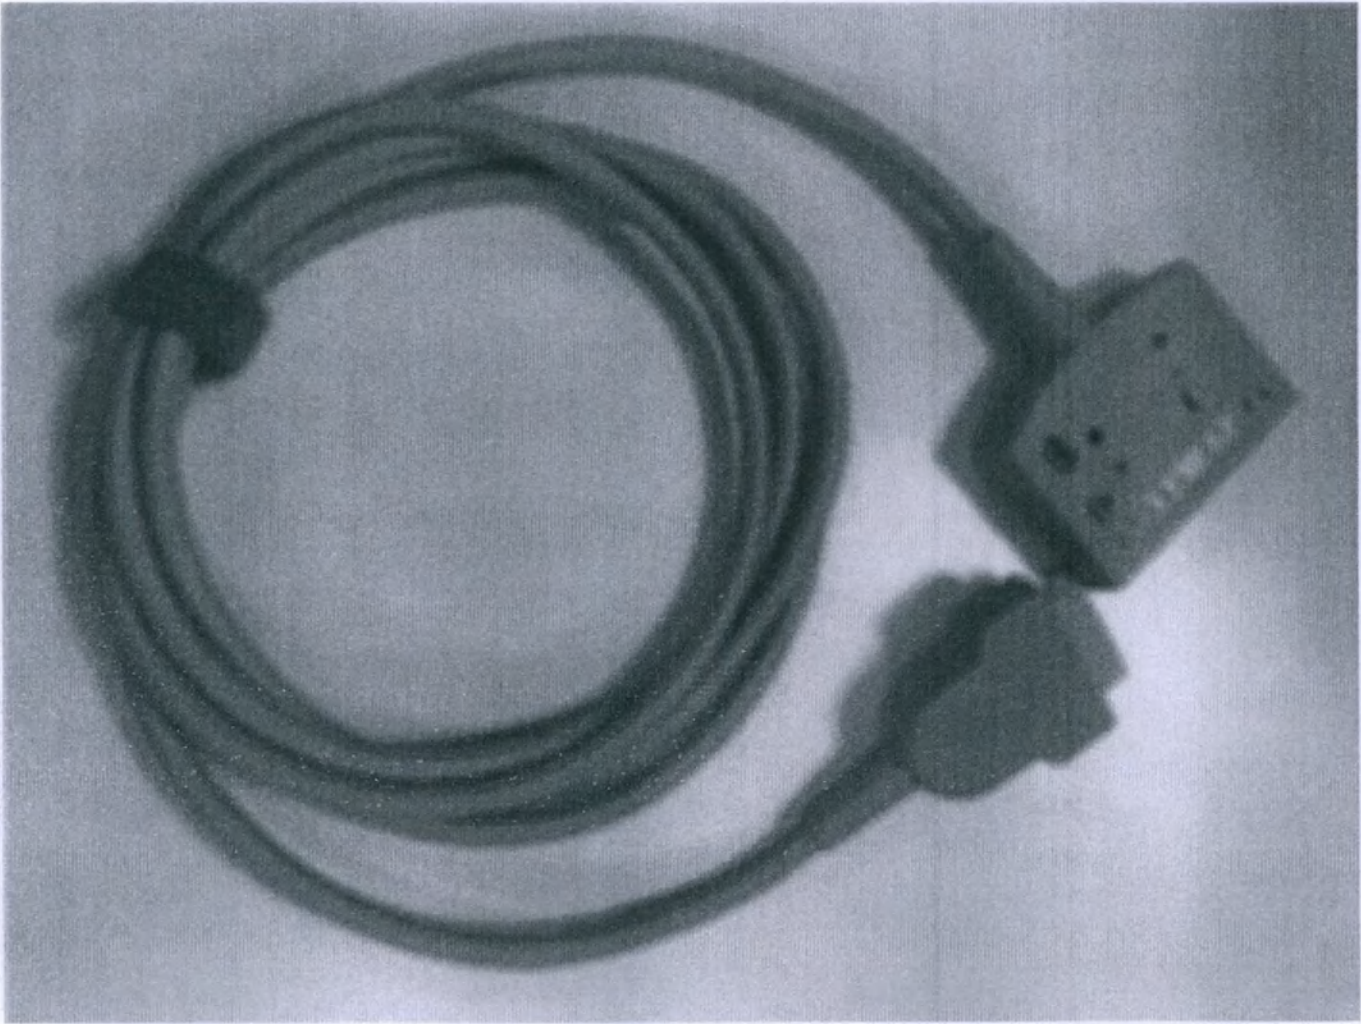


6. Кабели пациента интегрированные, IEC (не более 50 шт.) (при необходимости).


7. Кабели пациента интегрированные, АНА (не более 50 шт.) (при необходимости).

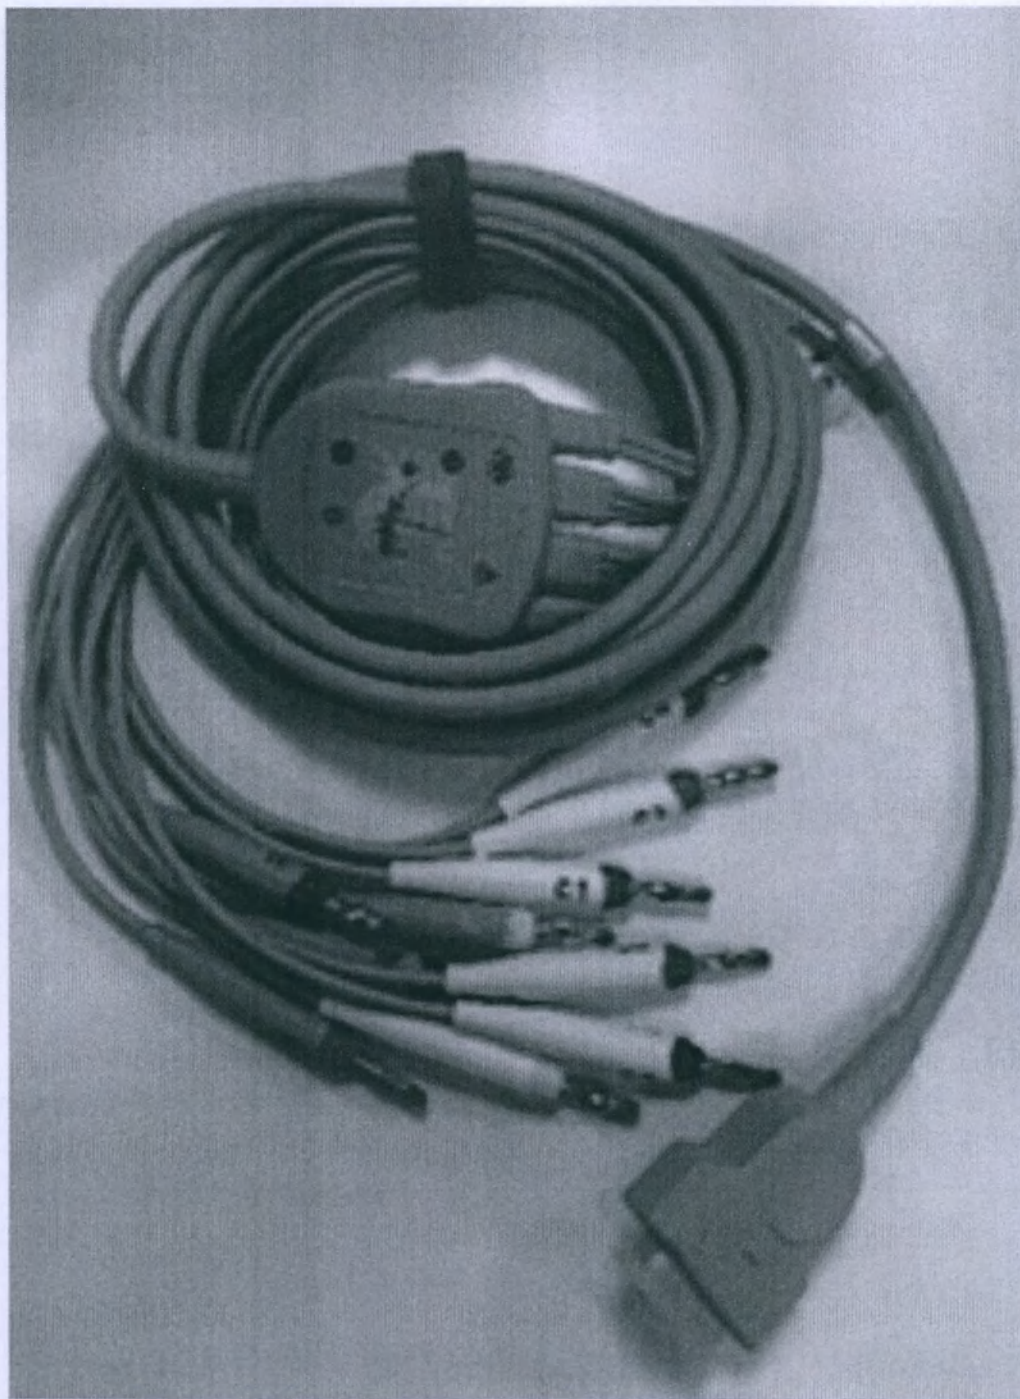


7. Кабели пациента интегрированные, АНА (не более 50 шт.) (при необходимости).

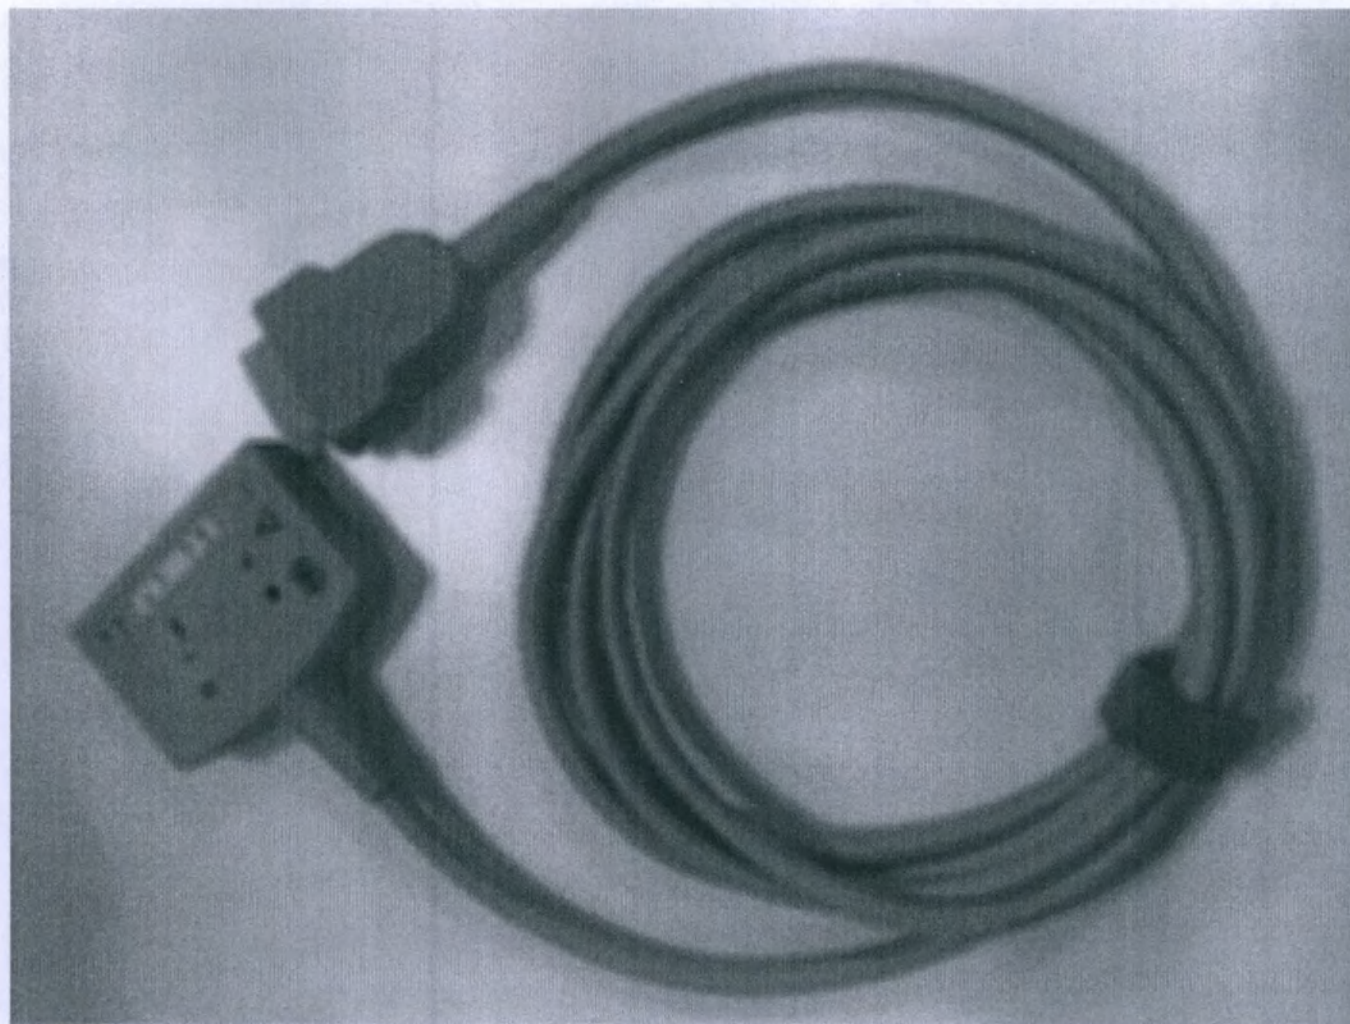


8. Кабели пациента магистральные АНА (не более 50 шт.) (при необходимости).

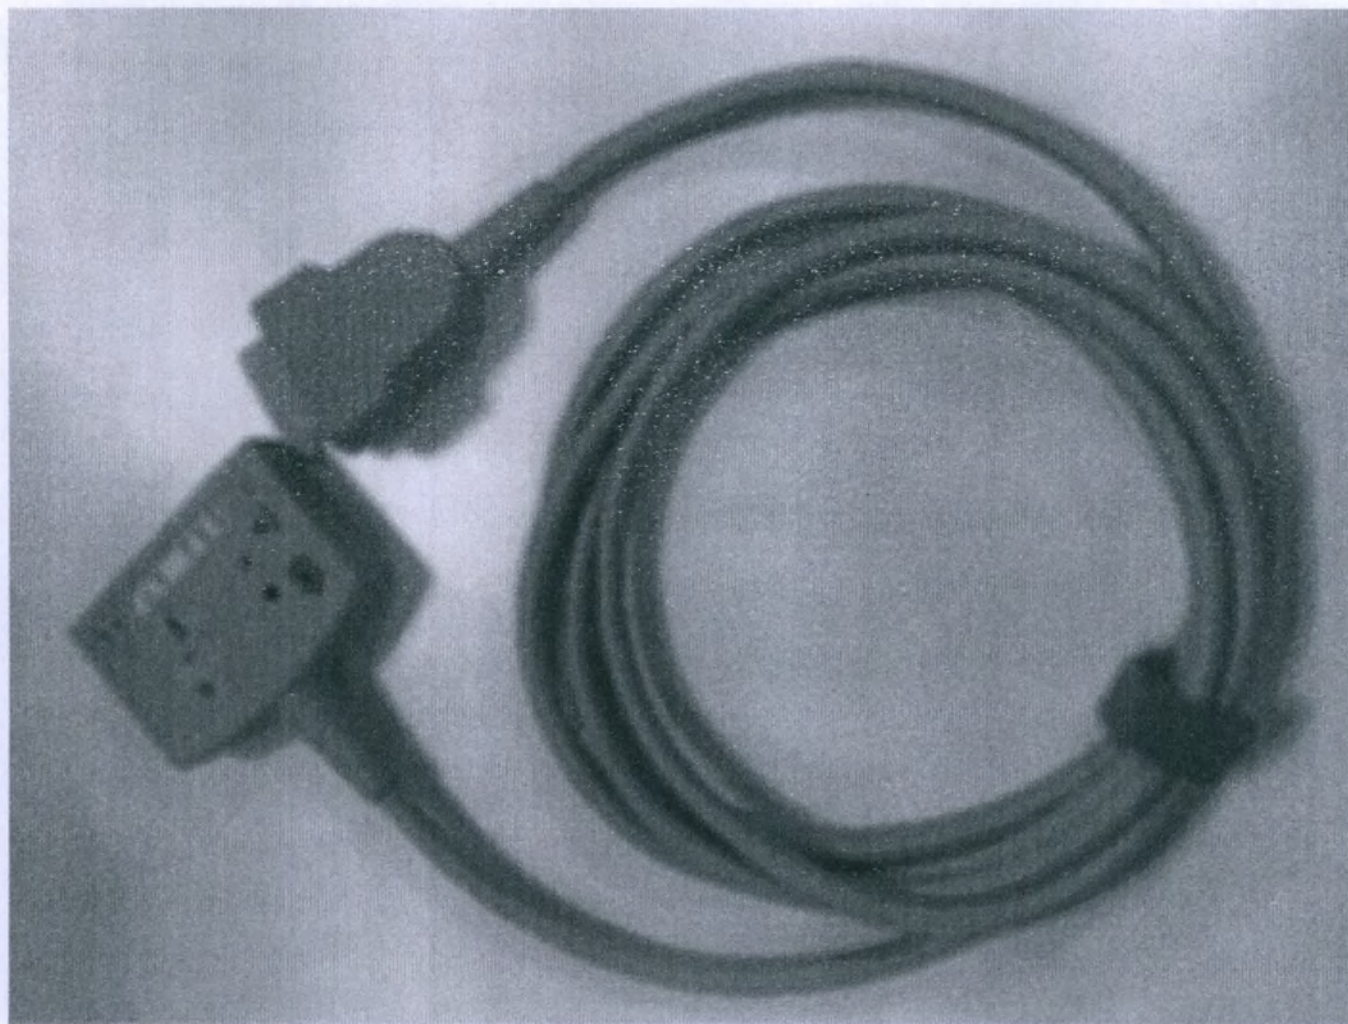

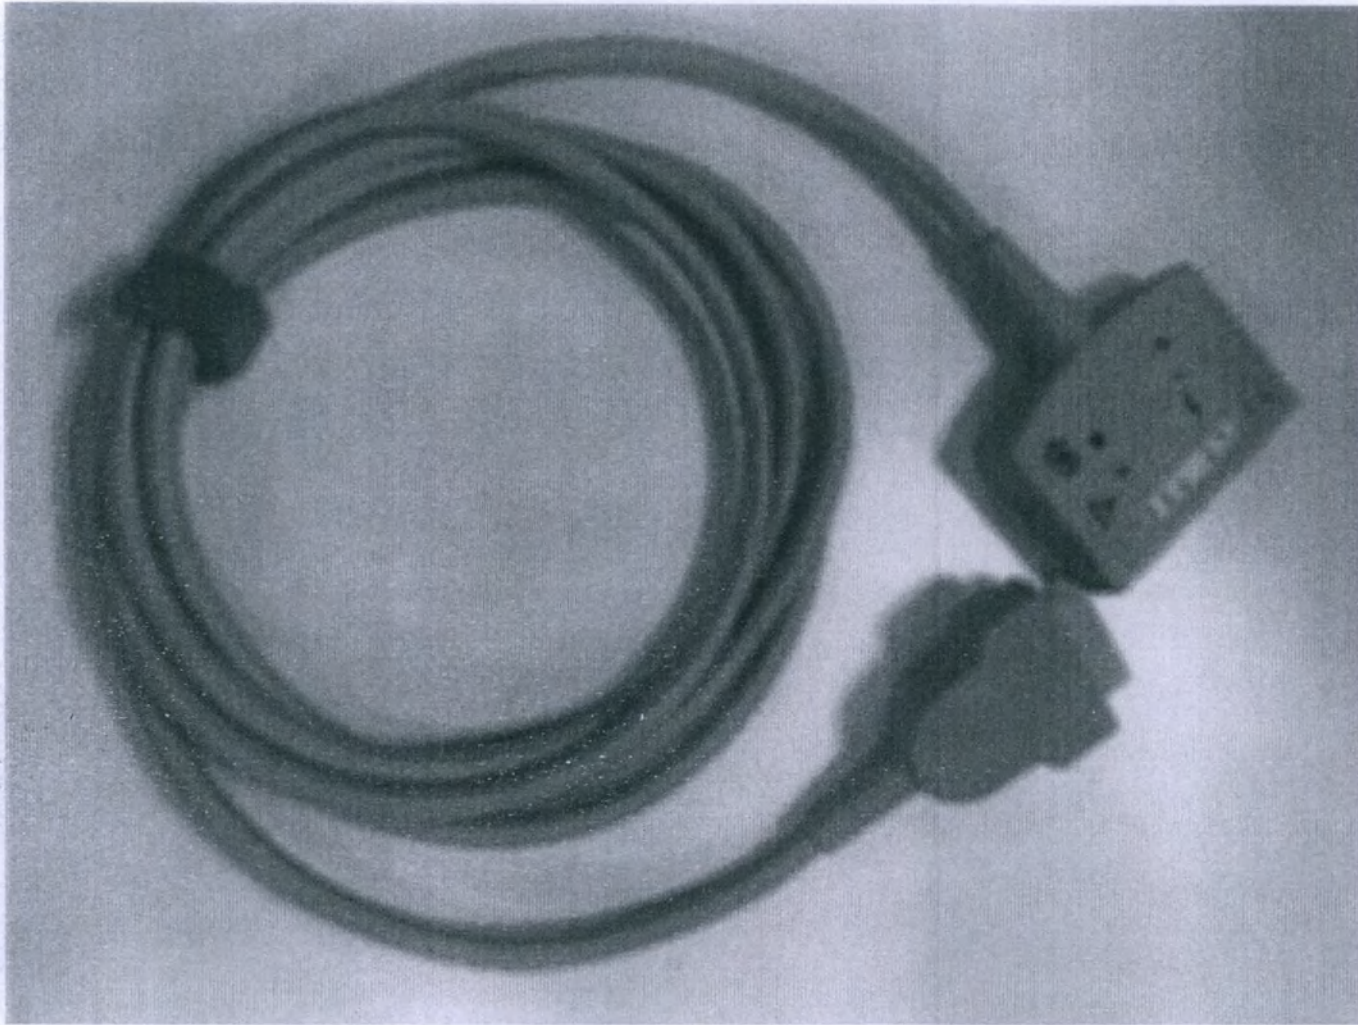


9. Кабели пациента матричные IEC (не более 50 шт.) (при необходимости).


10. Адаптеры для многоэлектродов типа Банан (не более 50 шт.) (при необходимости)

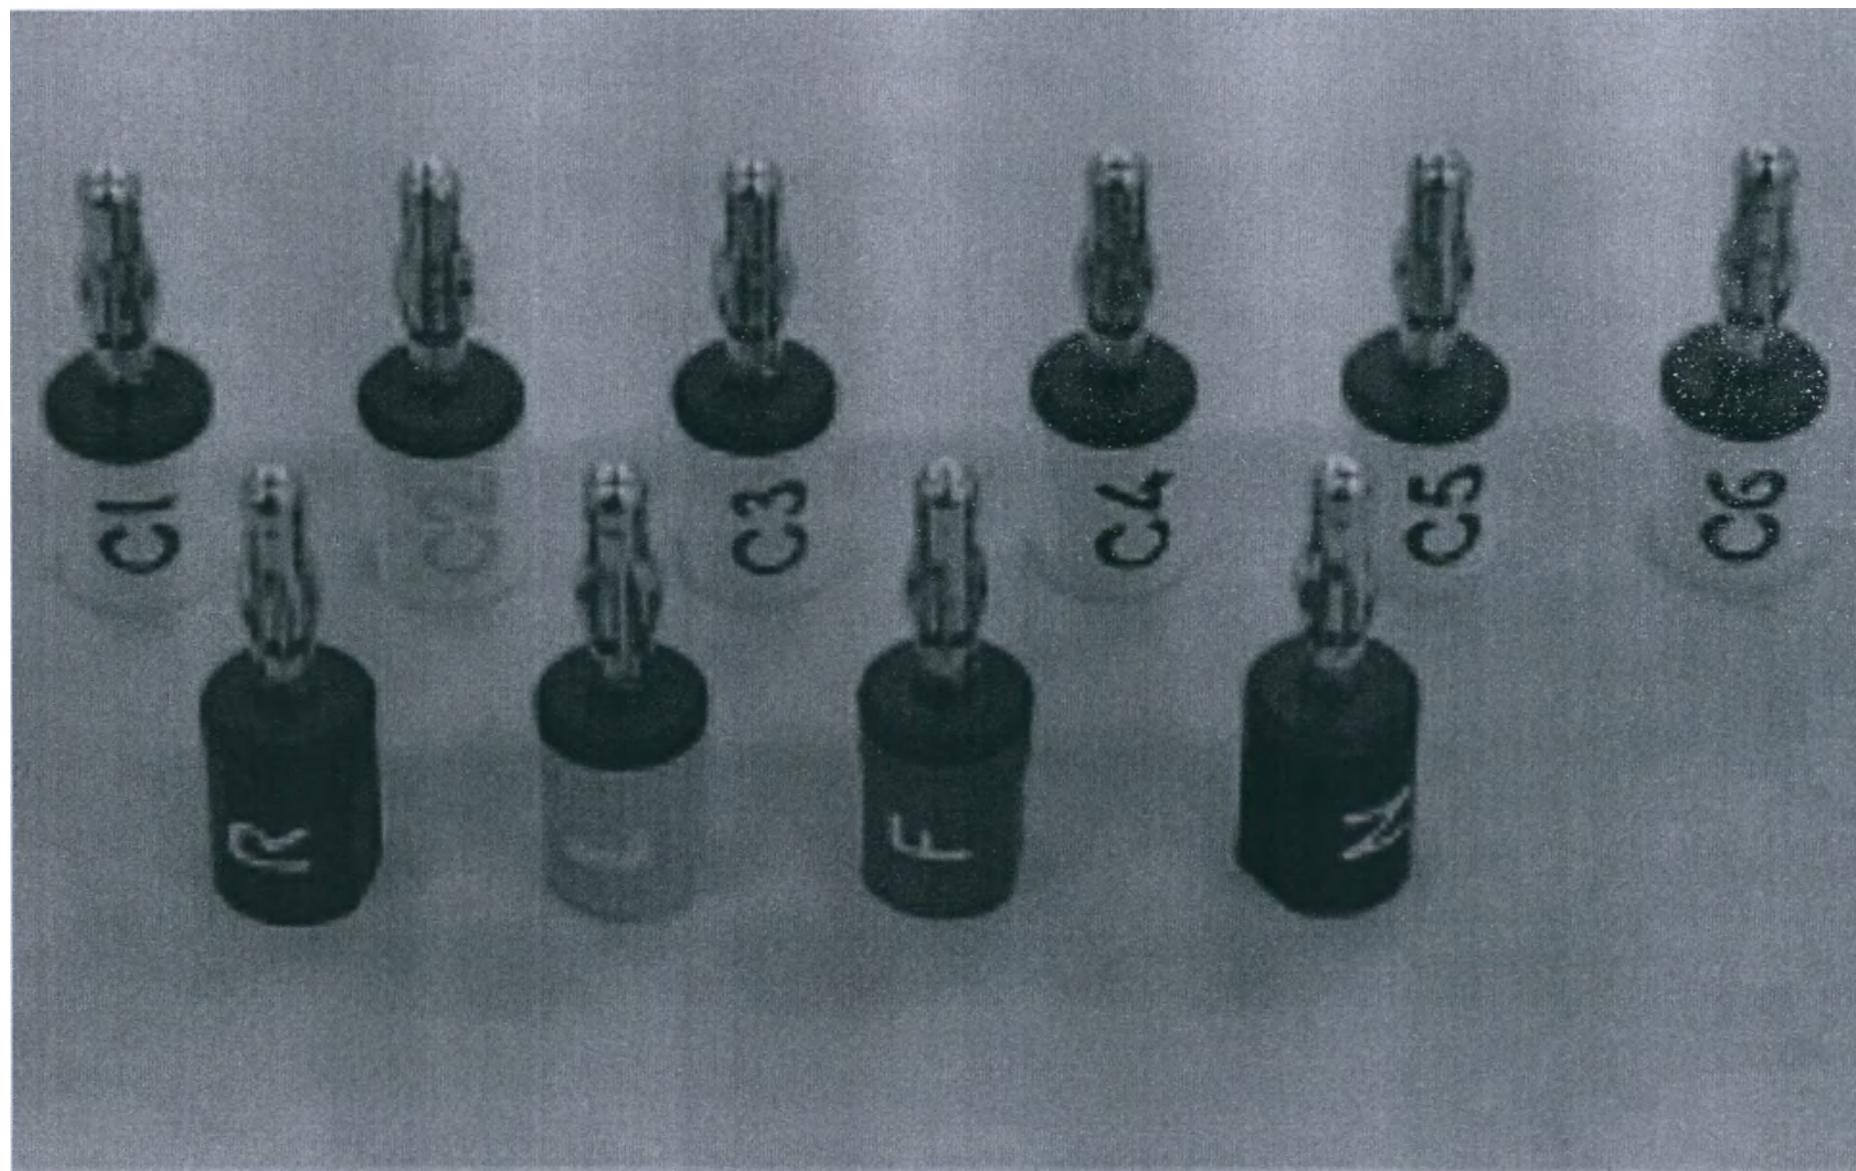


10. Адаптеры для многожильных электродов типа Банан (не более 50 шт.) (при необходимости)

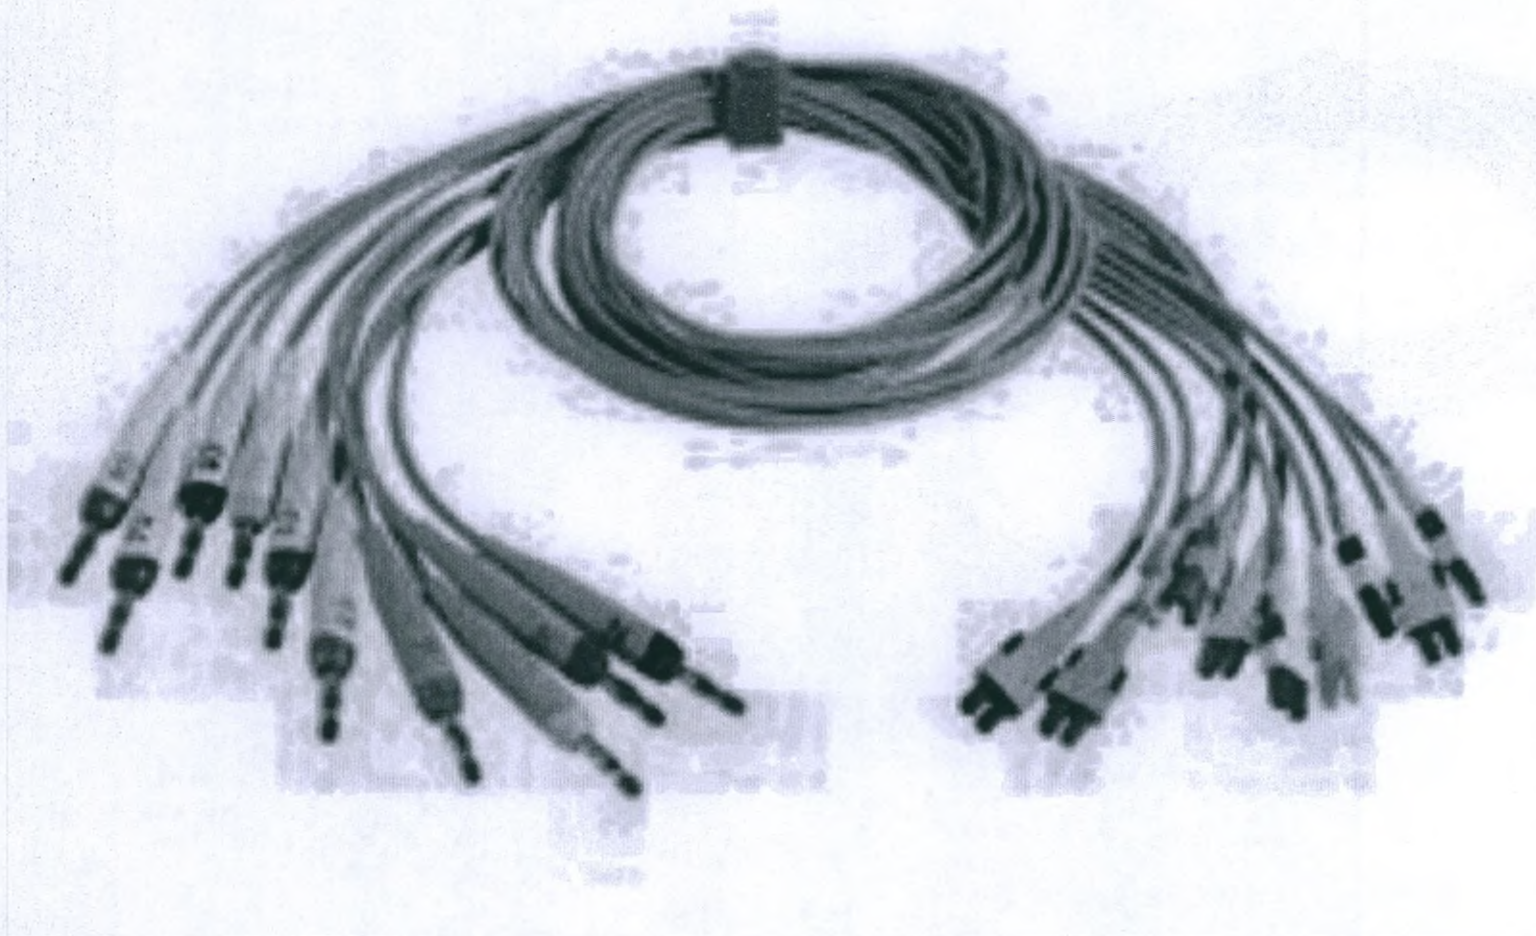


11. Адаптеры для многоэлектродов типа Габбер (не более 50 шт.) (при необходимости)

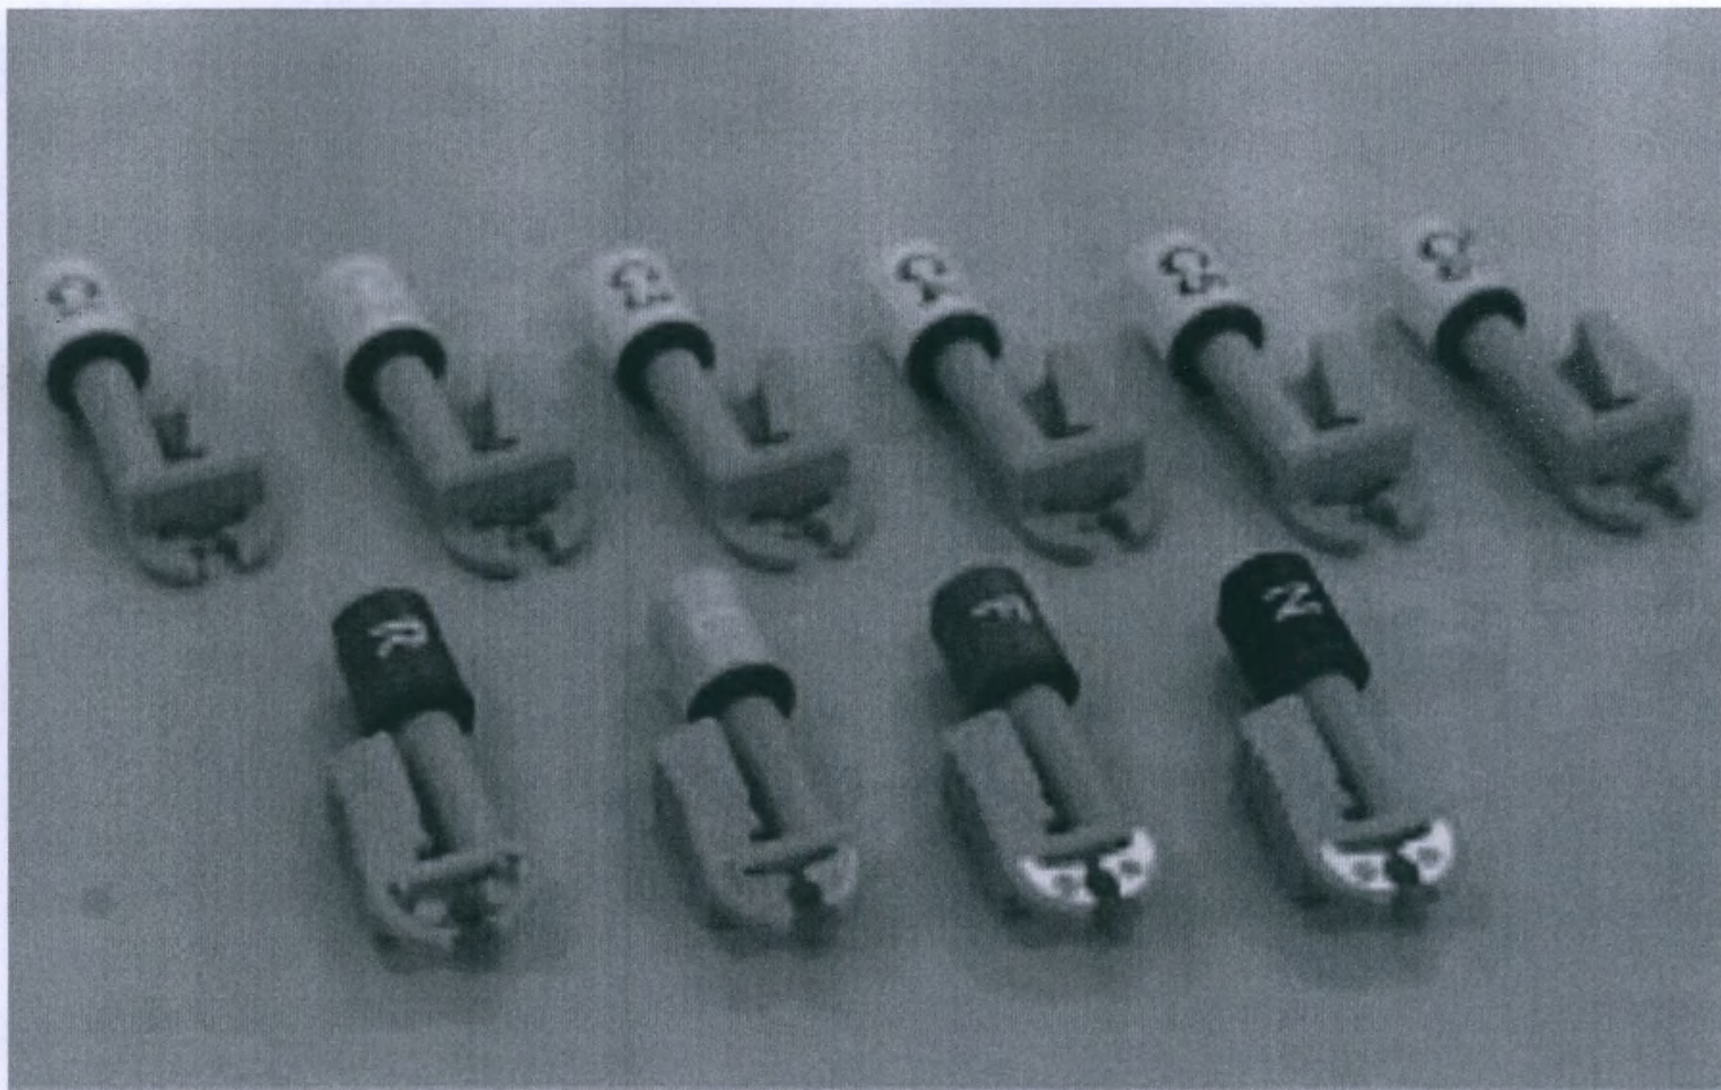

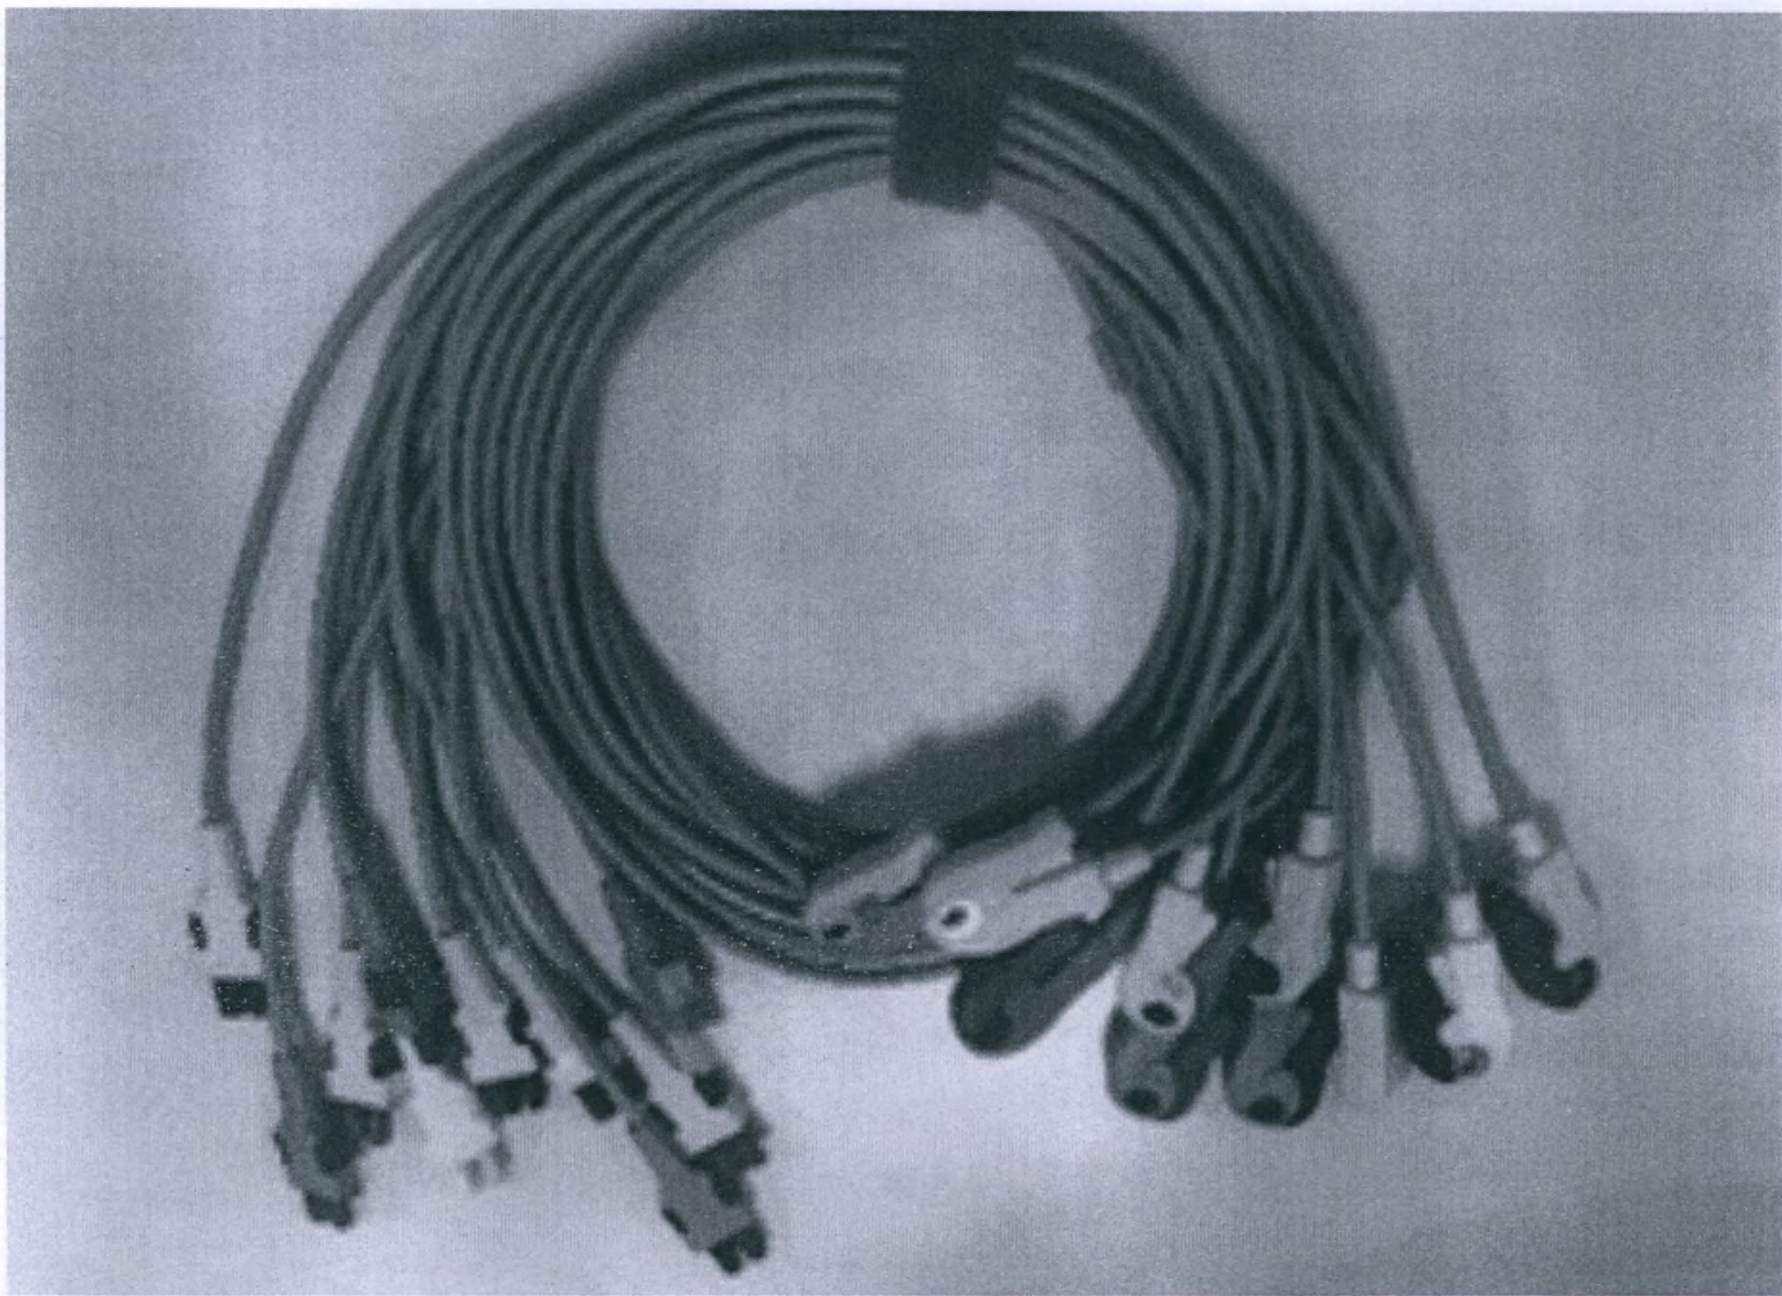


11. Адаптеры для многопарных электродов типа I раббер (не более 50 шт.) (при необходимости)


12. Набор отведений типа «граббер», 10 шт. в наборе, АНА (не более 50 шт.) (при необходимости)

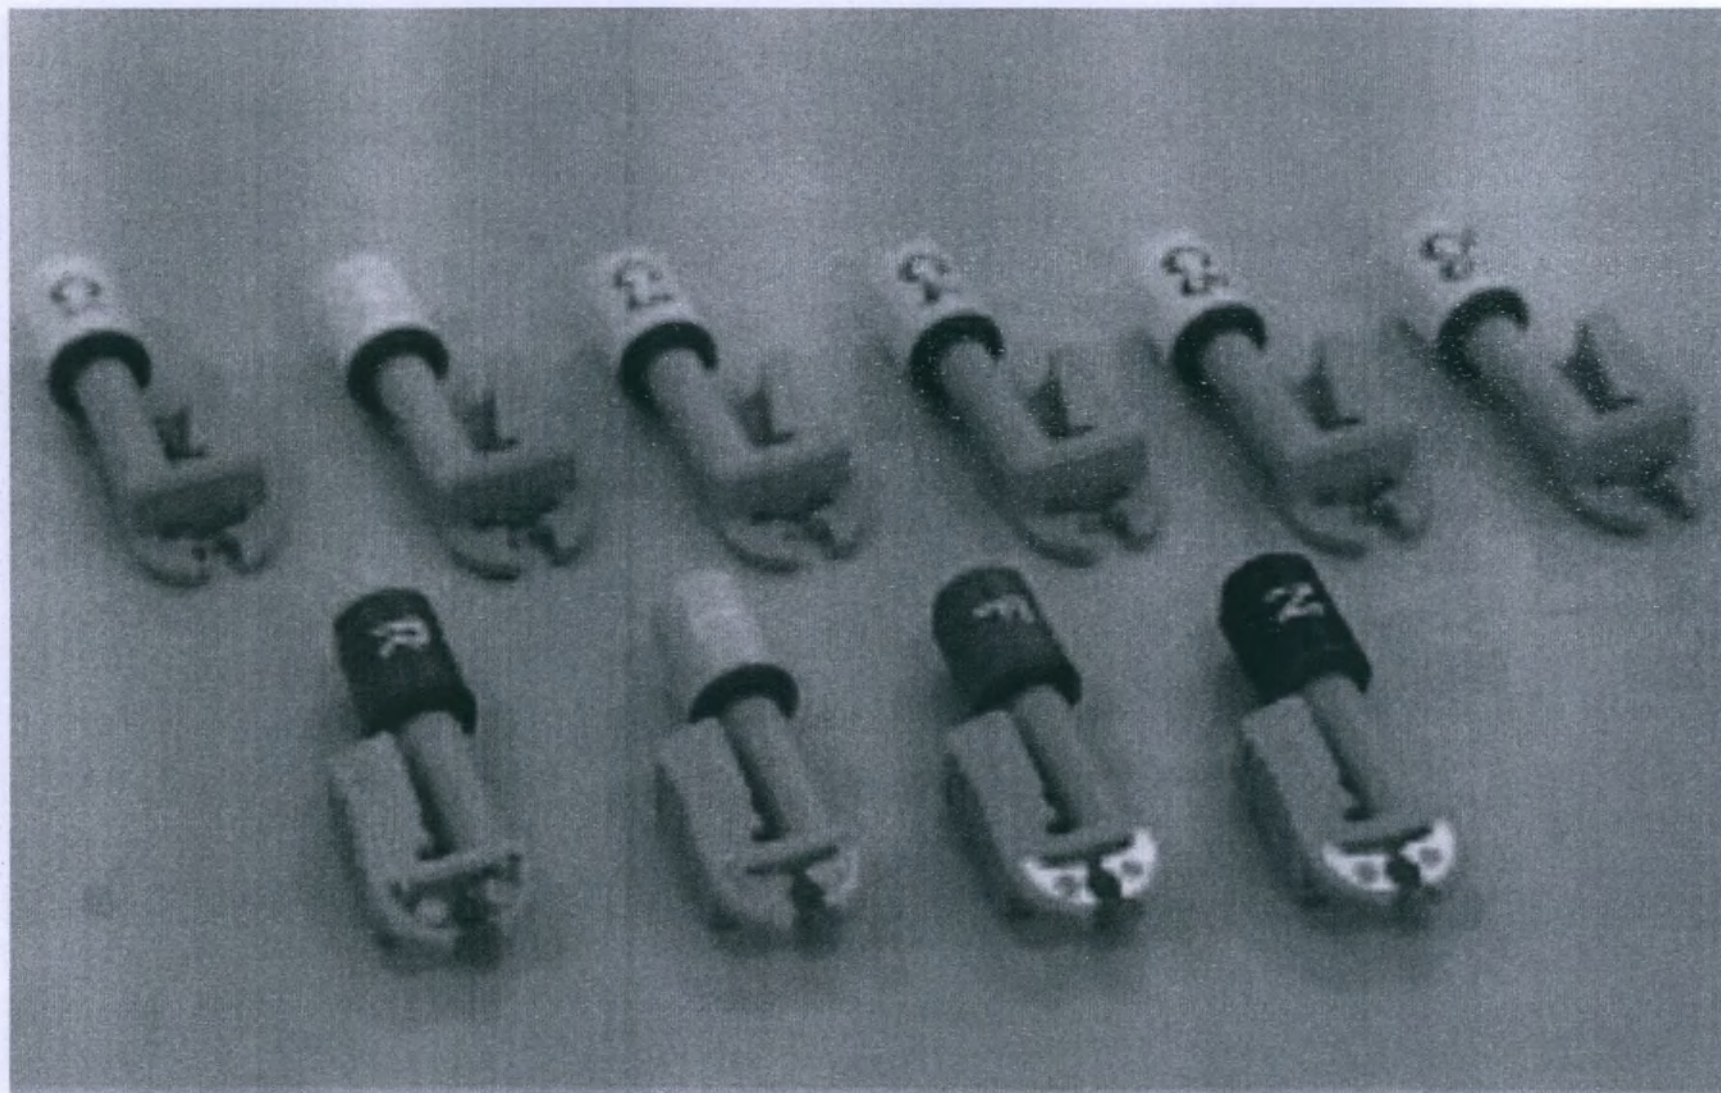


12. Набор отведений типа «граббер», 10 шт. в наборе, АНА (не более 50 шт.) (при необходимости)

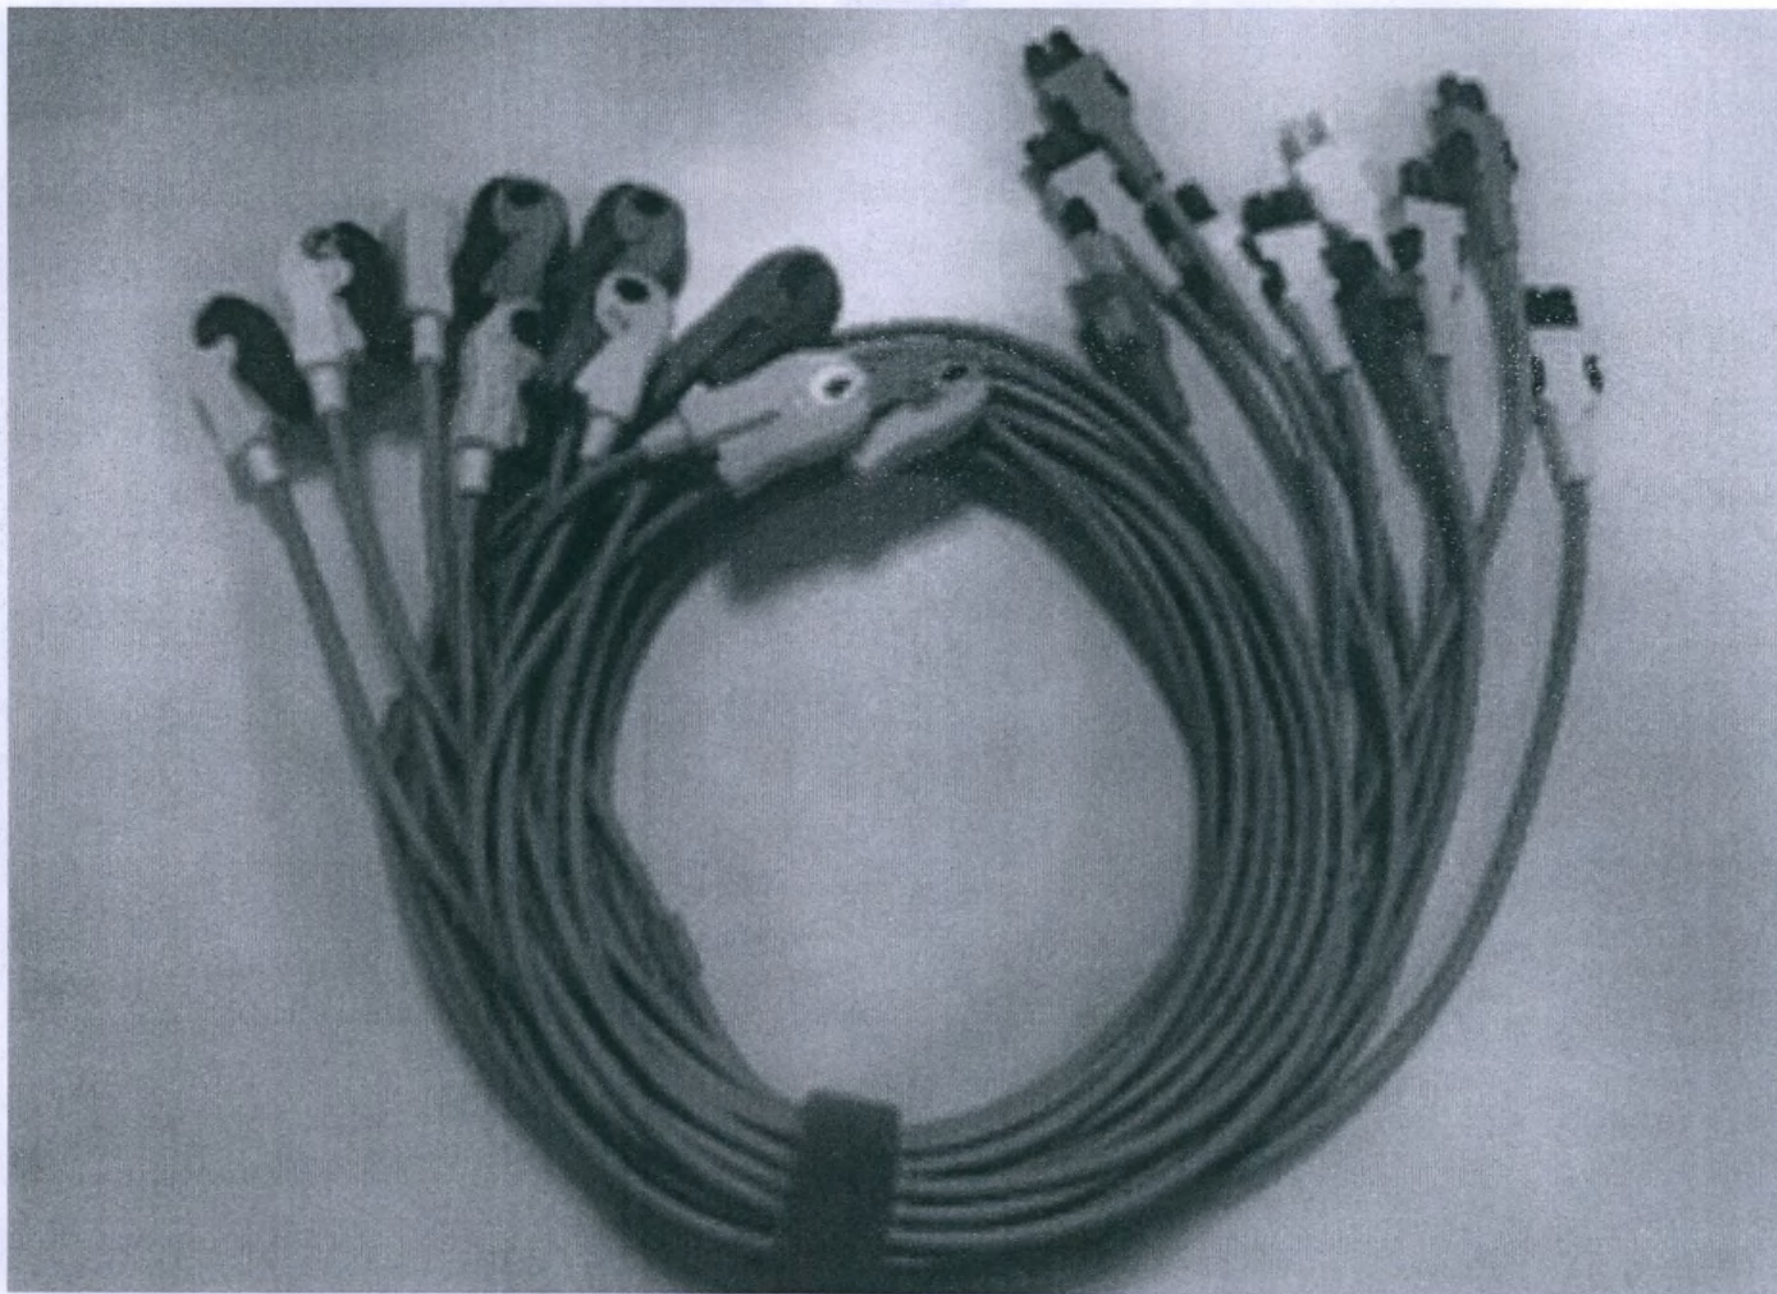


13. Переходники для ЭКГ (не более 10 упаковок) (при необходимости).

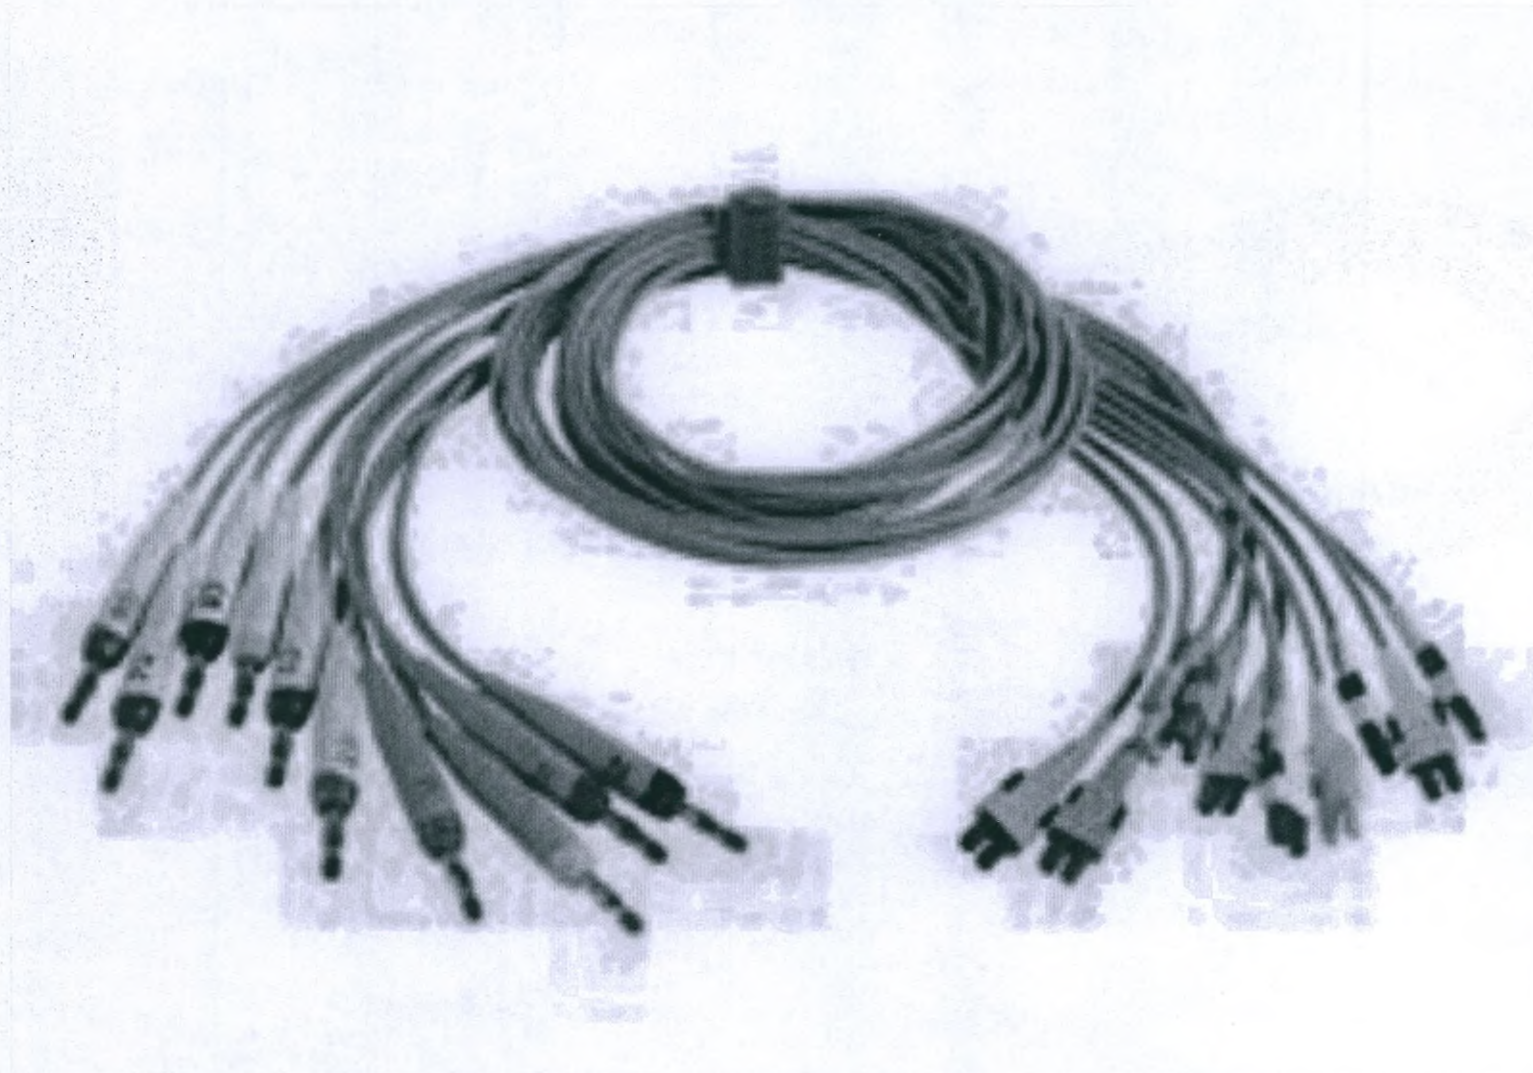


14. Набор дополнительных разъемов для ЭКГ типа банан, ИЕС, 4 шт. в упаковке (не более 10 упаковок) (при необходимости).

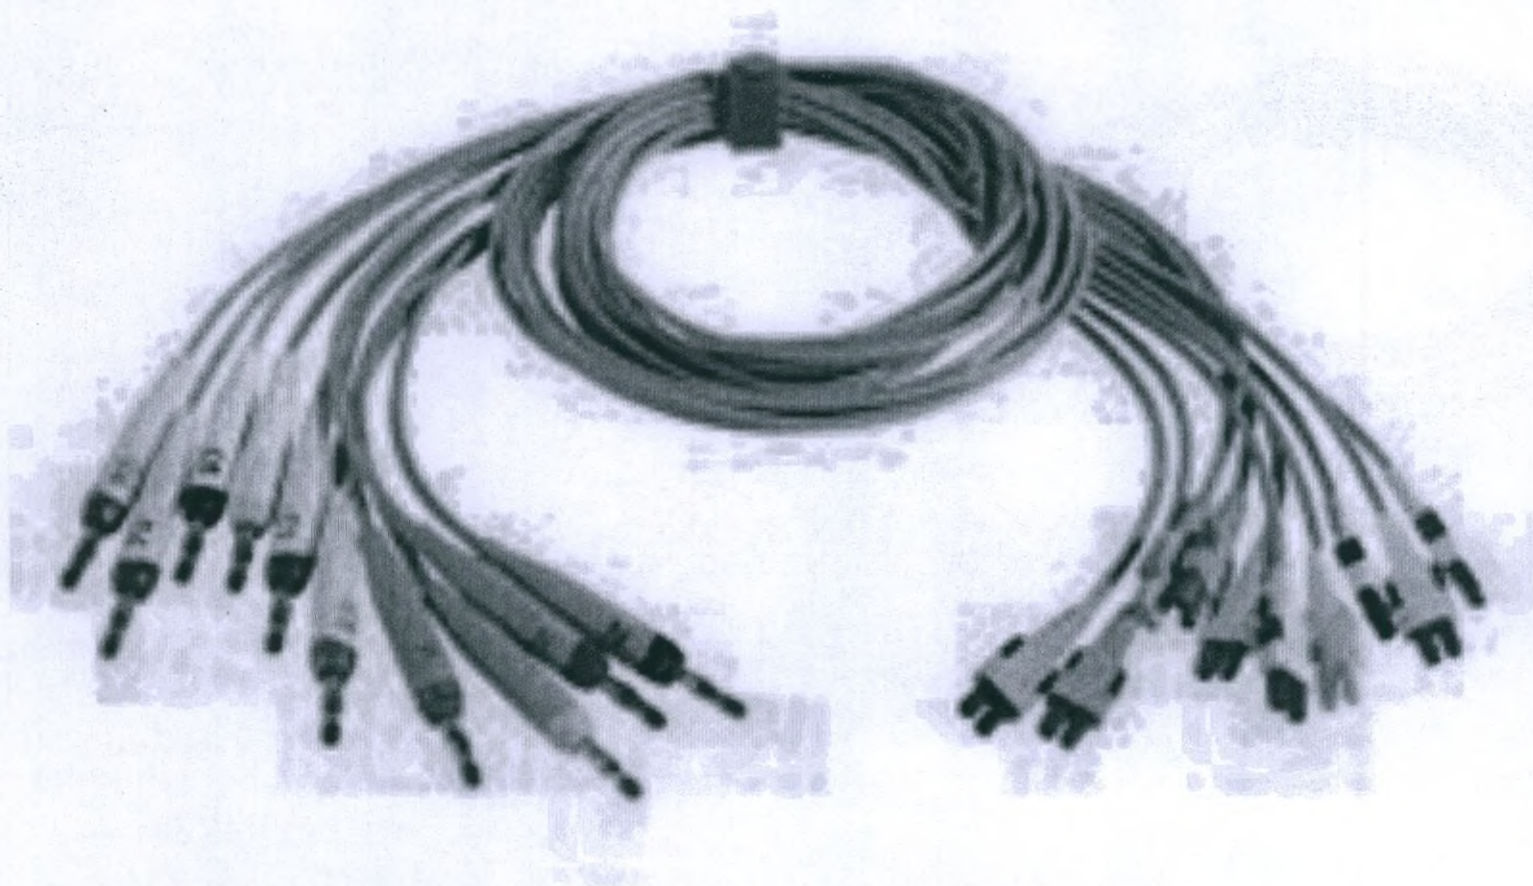


15. Разъем для ЭКГ (не более 10 упаковок) (при необходимости).

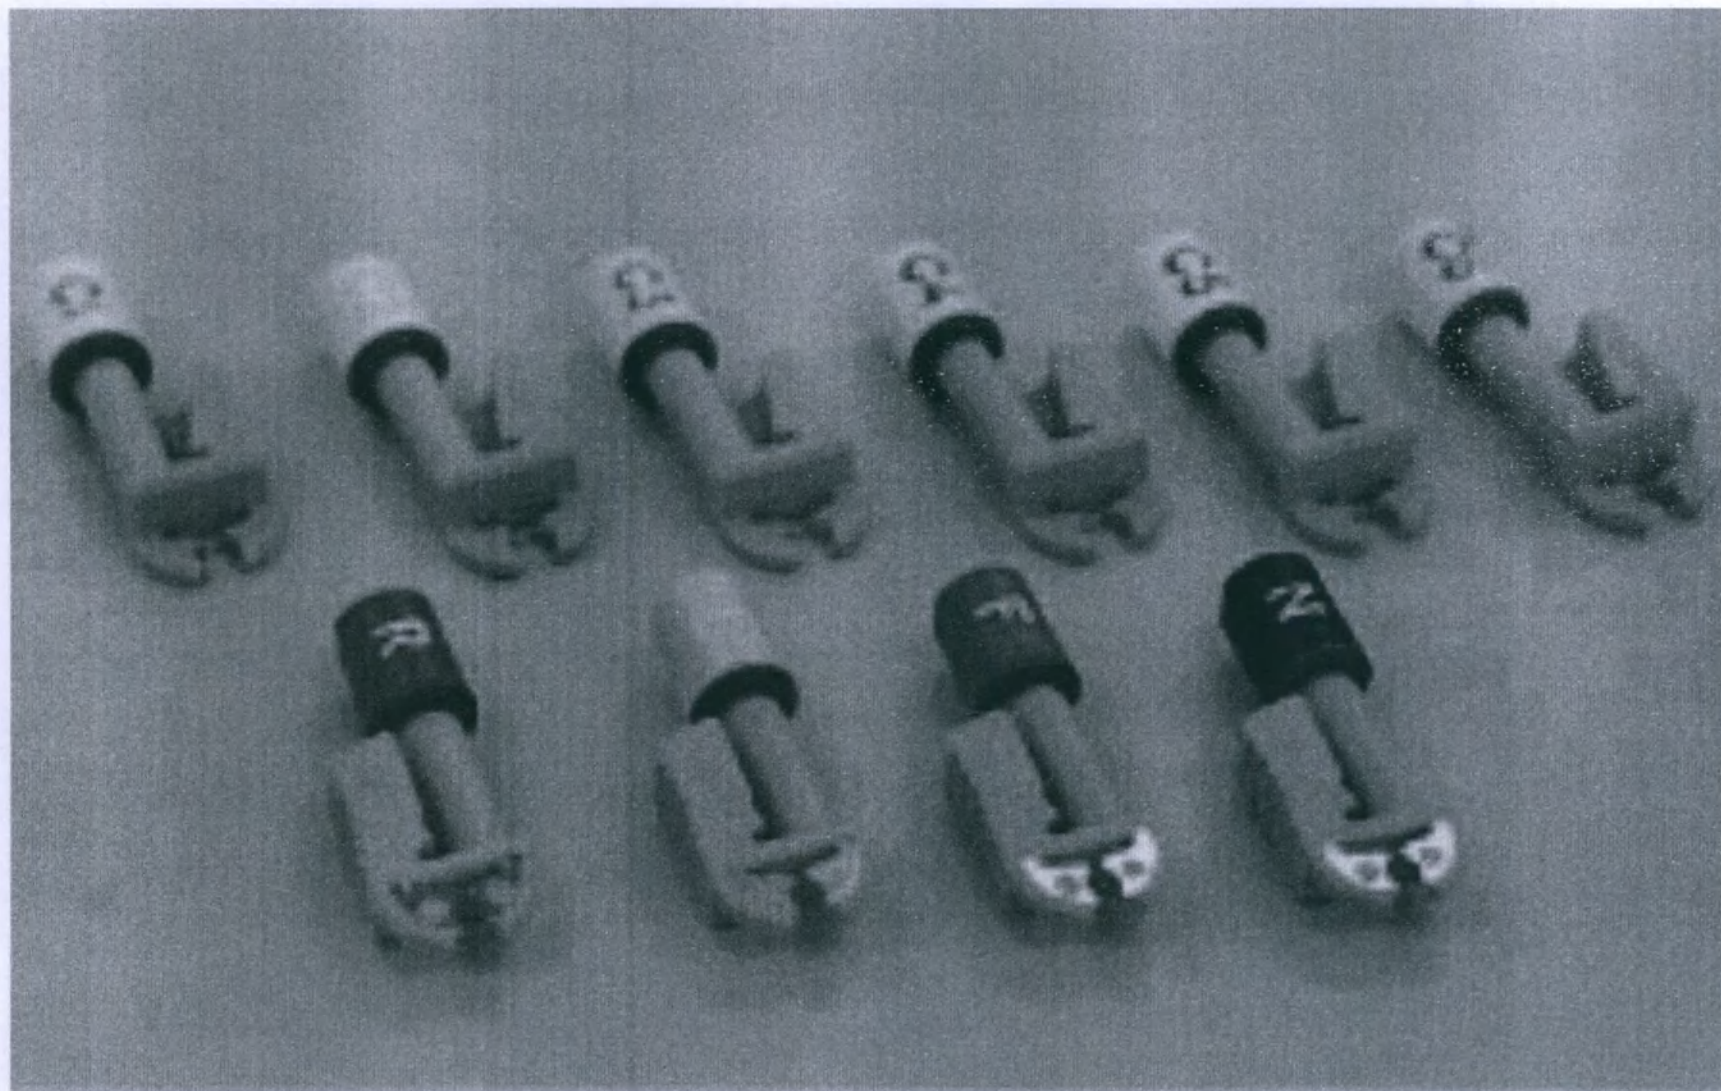

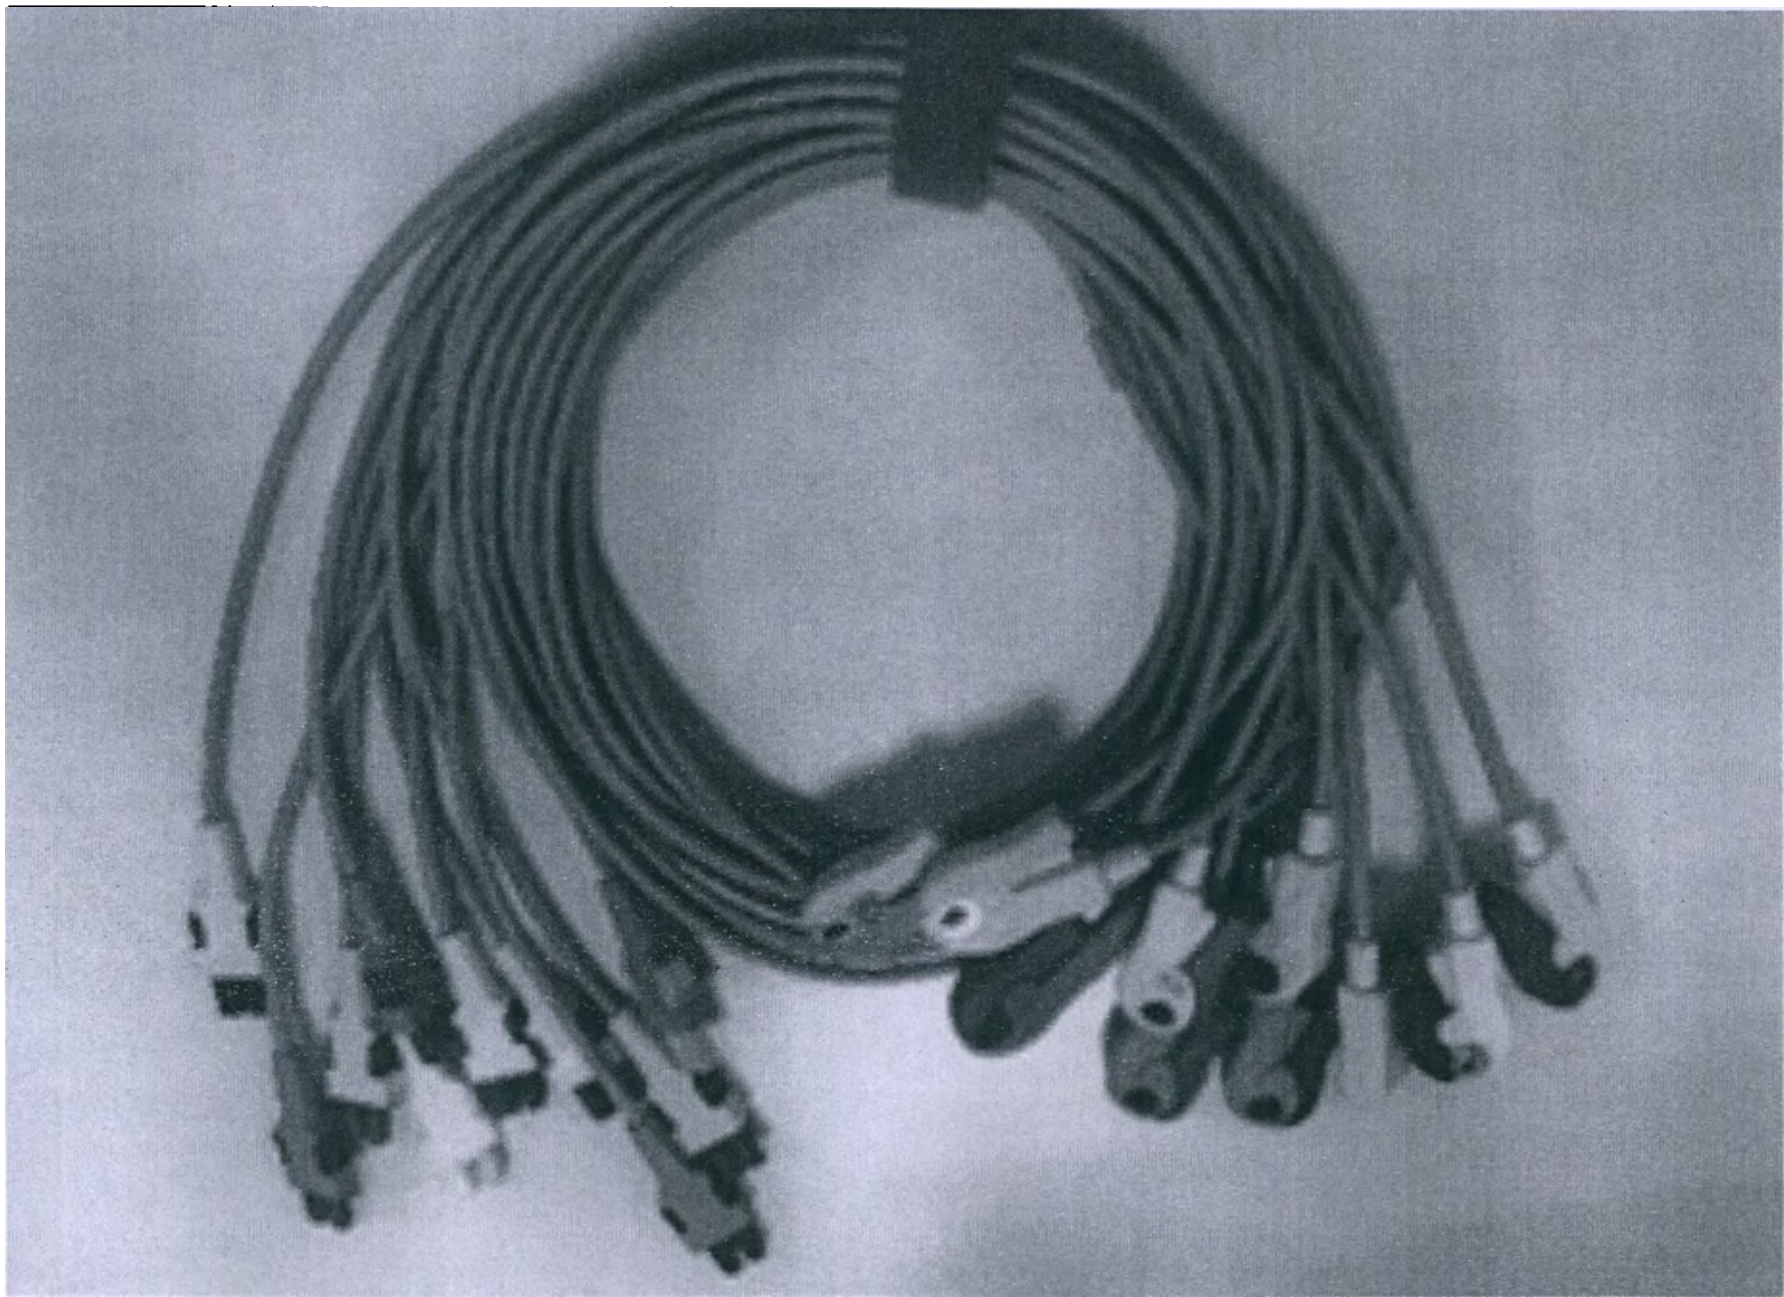


15. Разъем для ЭКГ (не более 10 утиковок) (при необходимости).


16. Набор дополнительных разъемов для ЭКГ с захватом, ИЕС, 4 шт. в упаковке (не более 10 упаковок) (при необходимости).

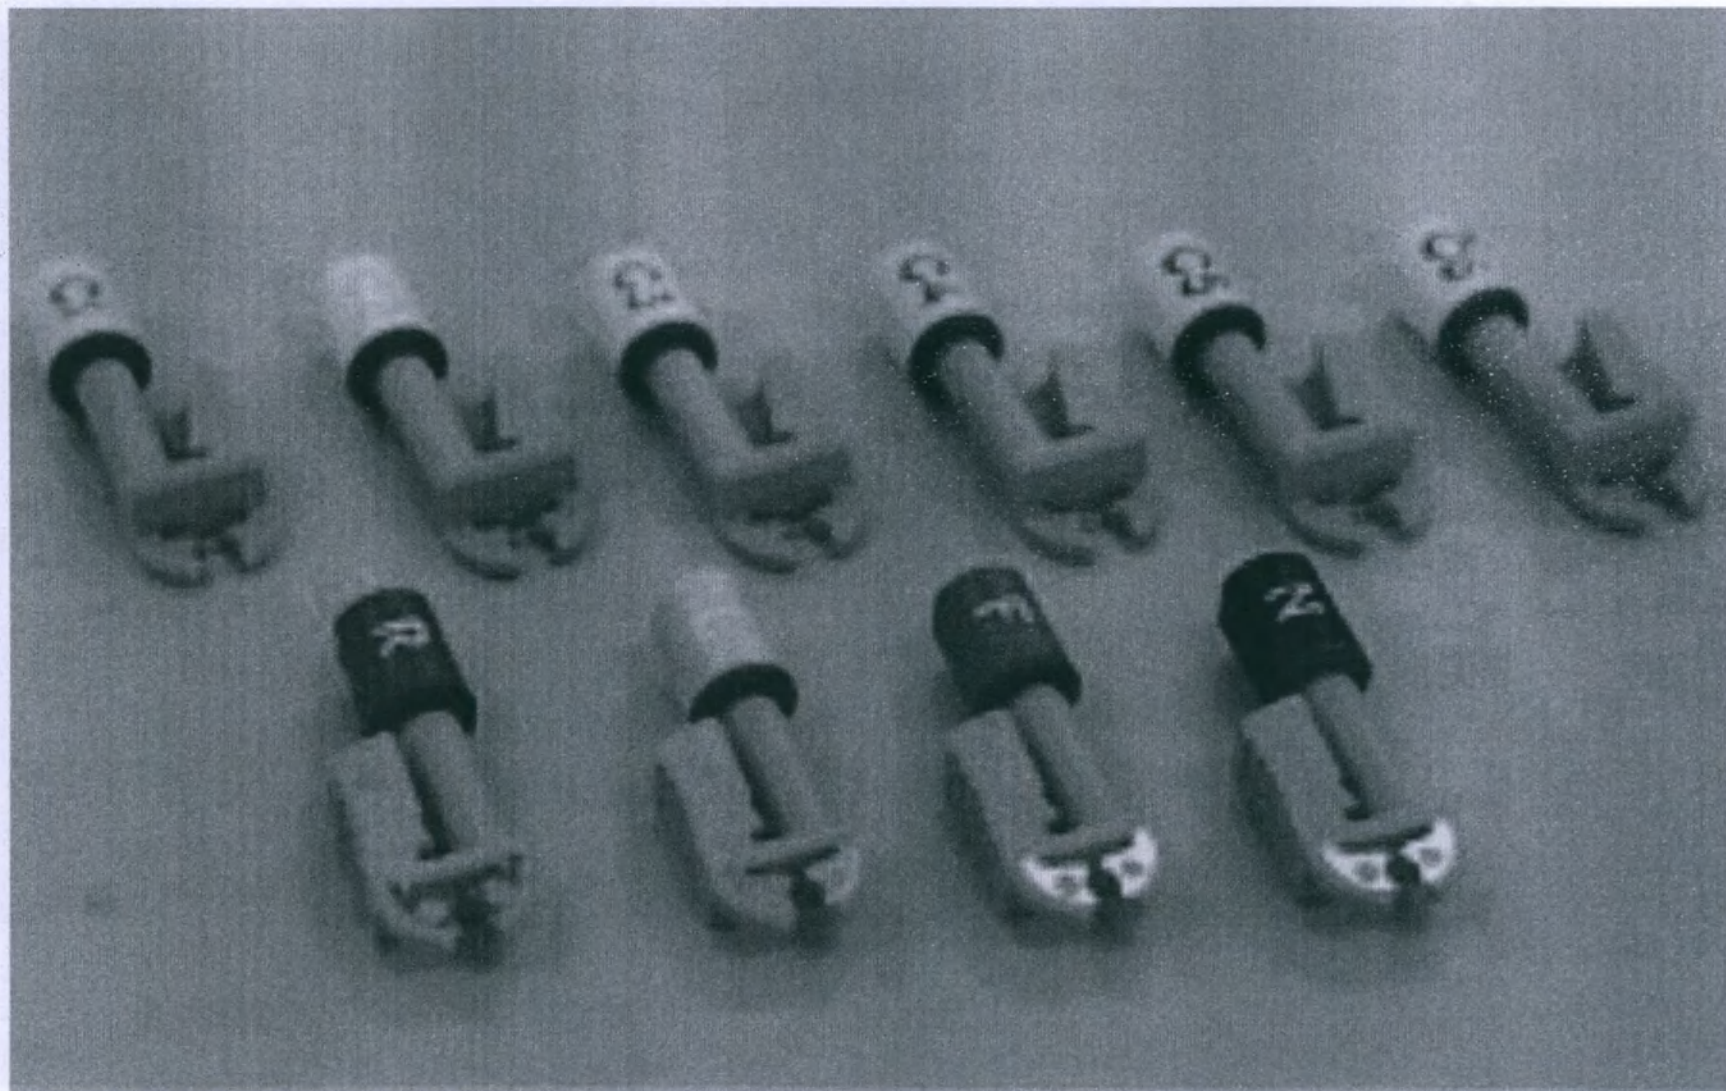


16. Набор дополнительных разъемов для ЭКГ с захватом, ИЕС, 4 шт. в упаковке (не более 10 упаковок) (при необходимости).

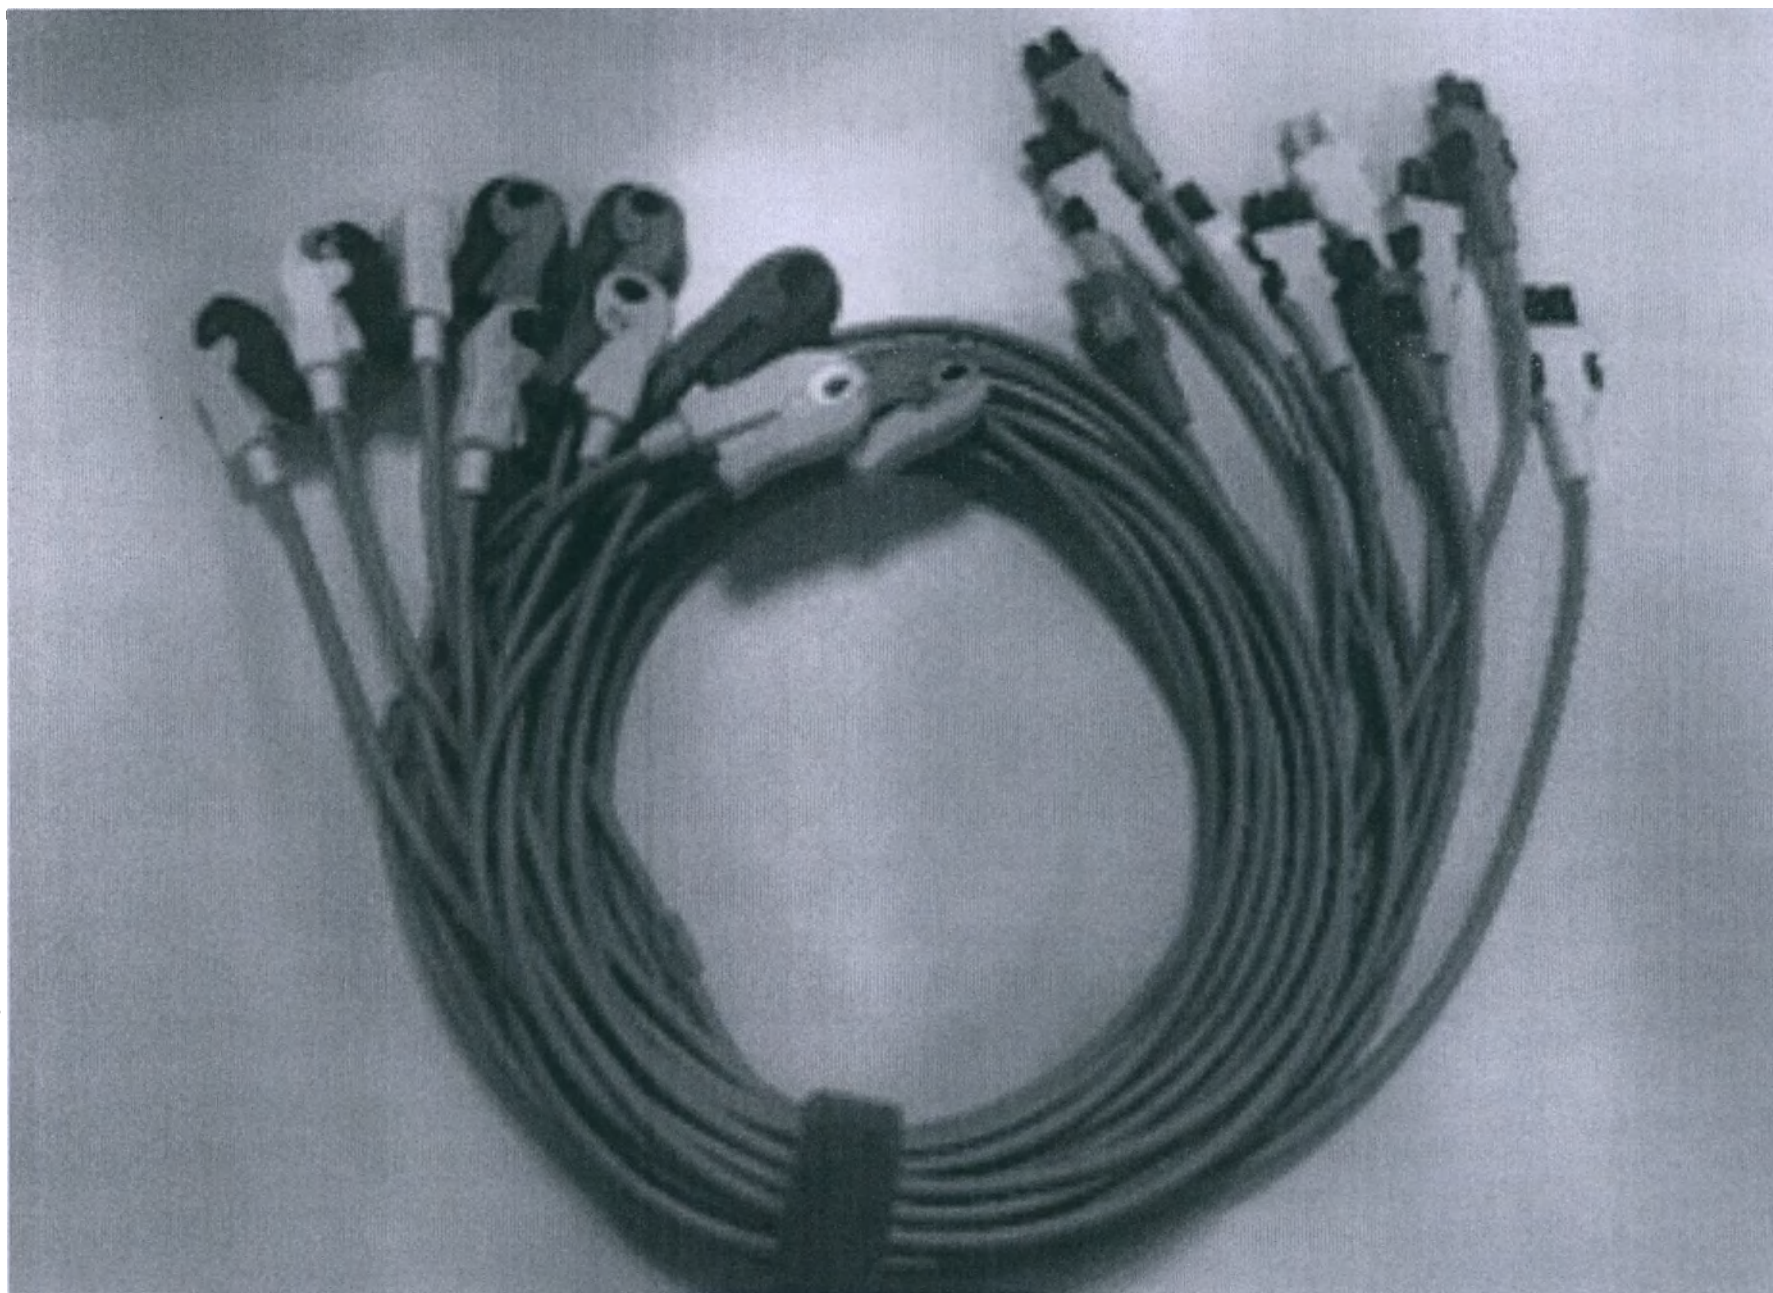



**17. Адаптеры-переходники многофункциональные для регистрации ЭКГ с помощью одноразовых электродов (не более 100 шт.)
(при необходимости)**

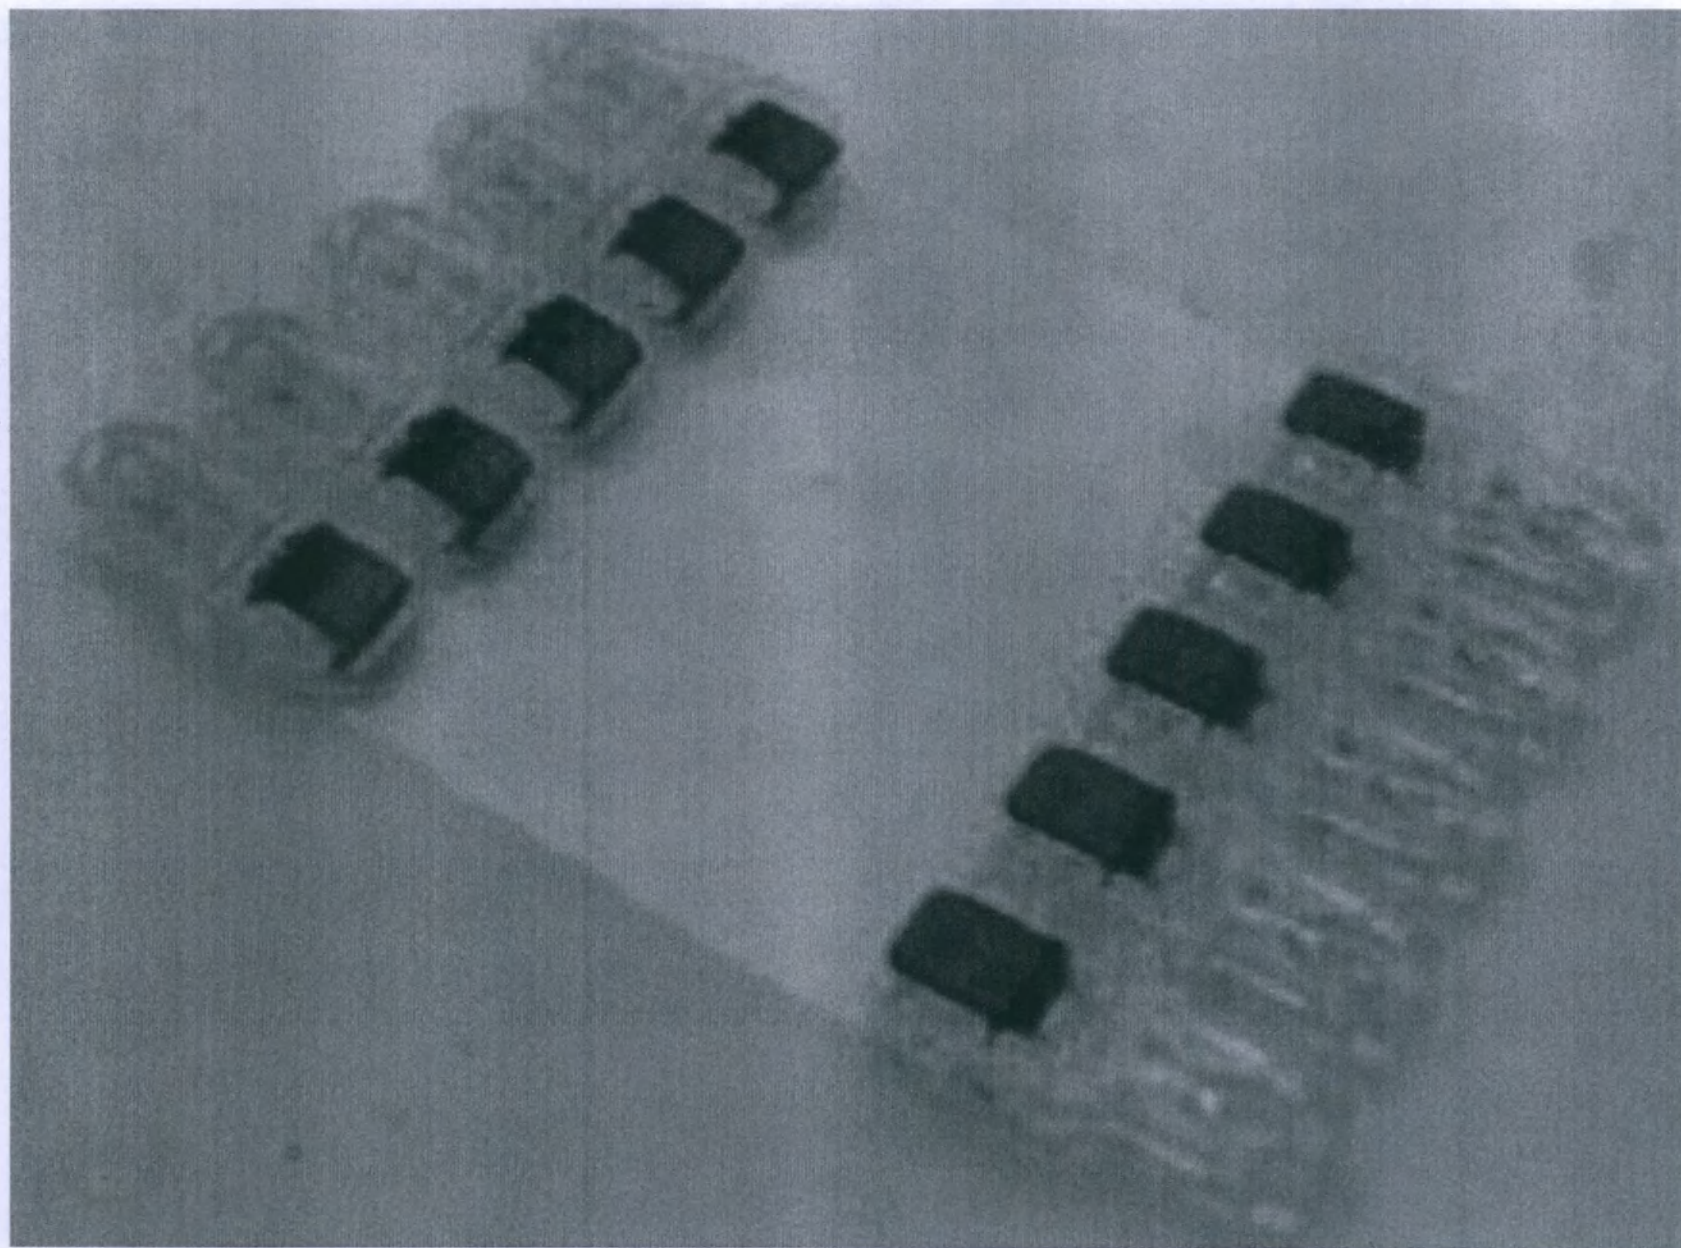


18. Одноразовые адгезивные электроды маленького размера для снятия ЭКГ у младенцев (не более 12000 шт.) (при необходимости).

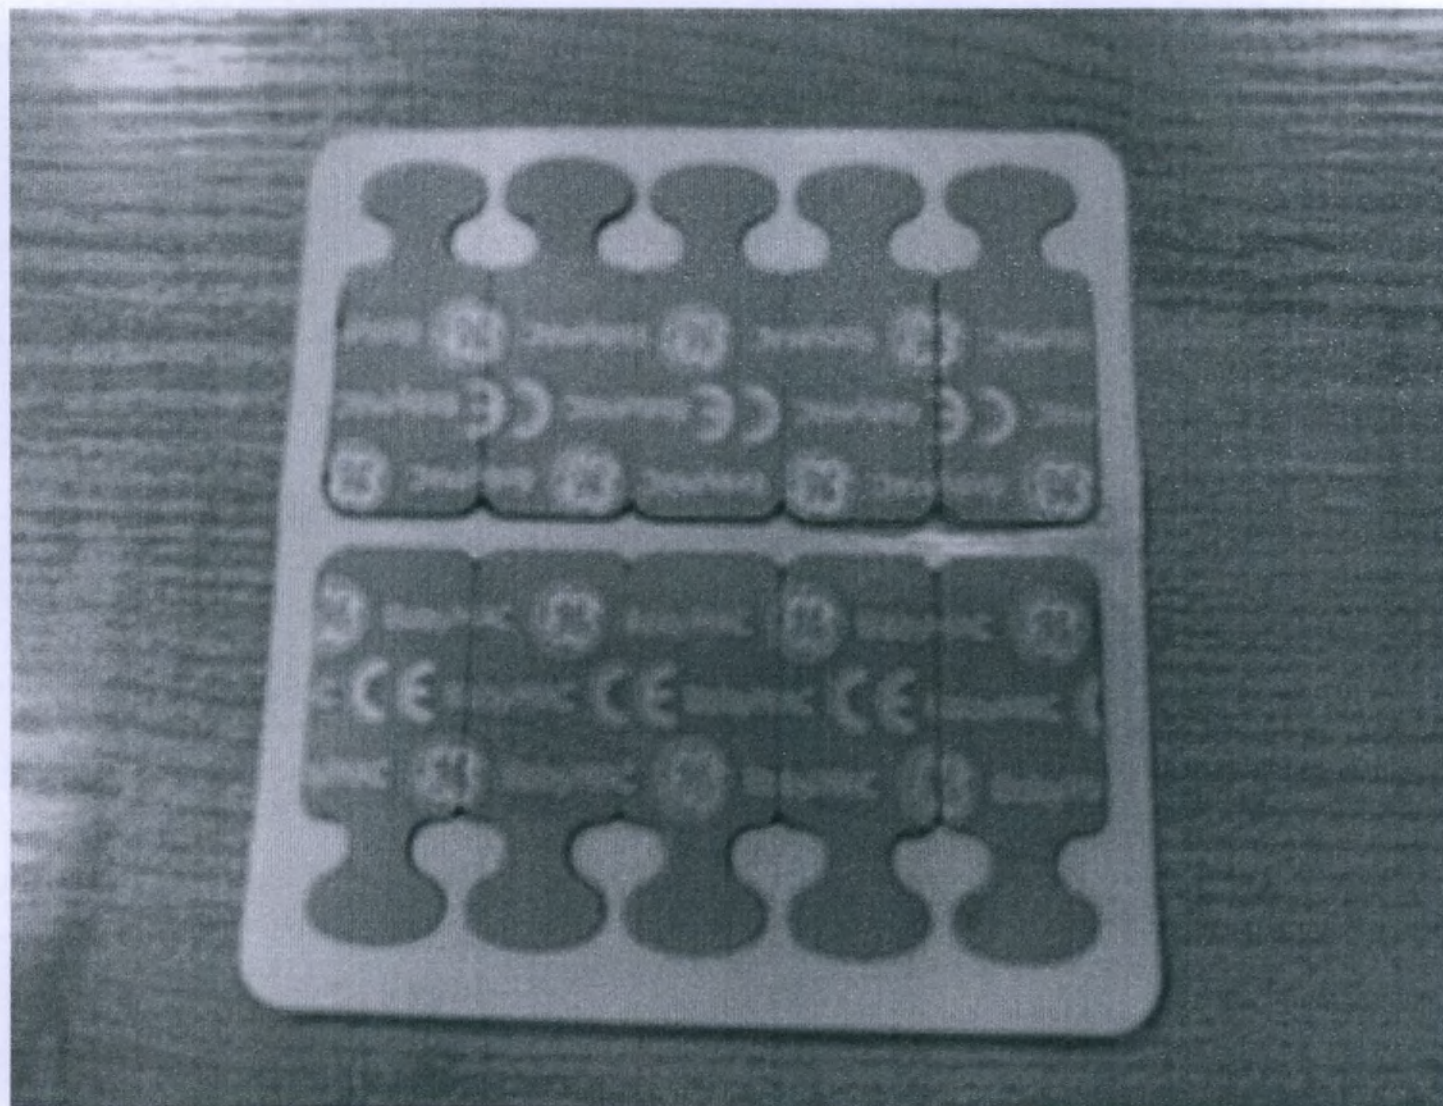


19. Одноразовые адгезивные электроды большого размера для снятия ЭКГ у взрослых (не более 12000 шт.) (при необходимости).

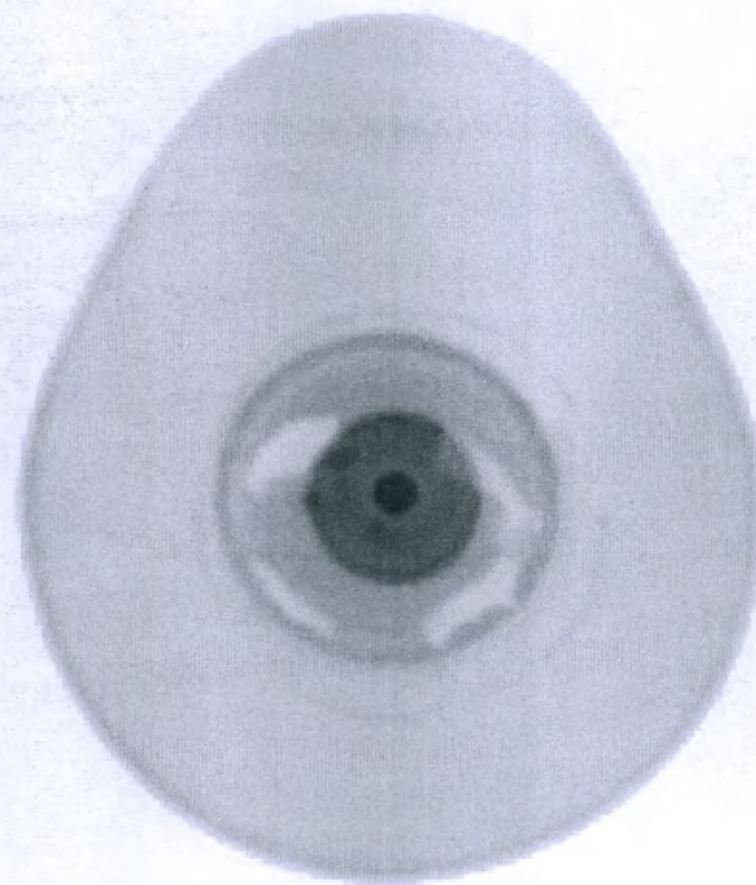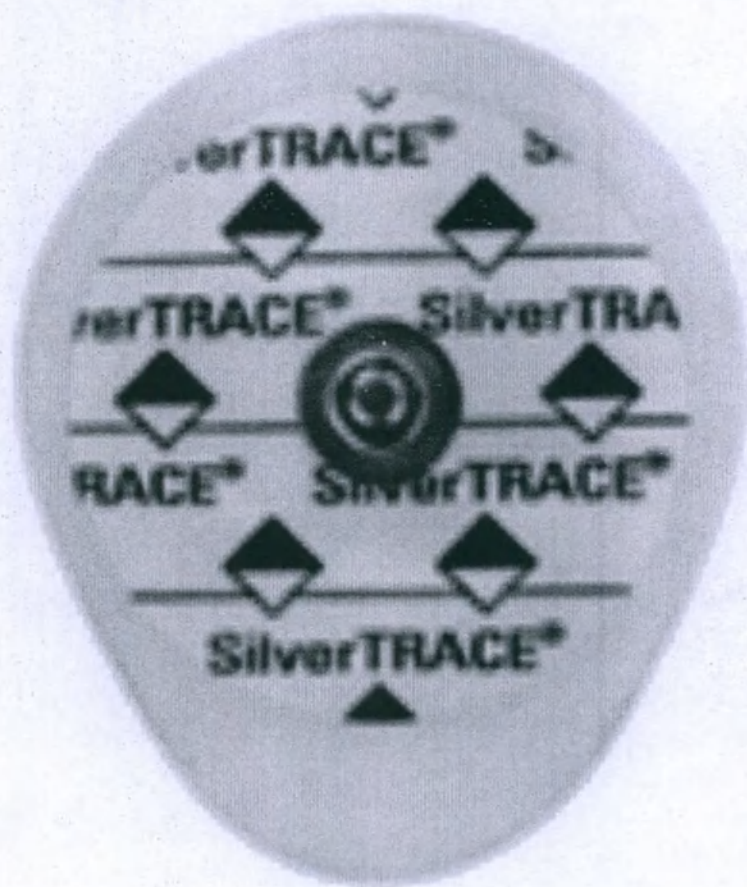


19. Одноразовые адгезивные электроды большого размера для снятия ЭКГ у взрослых (не более 12000 шт.) (при необходимости).

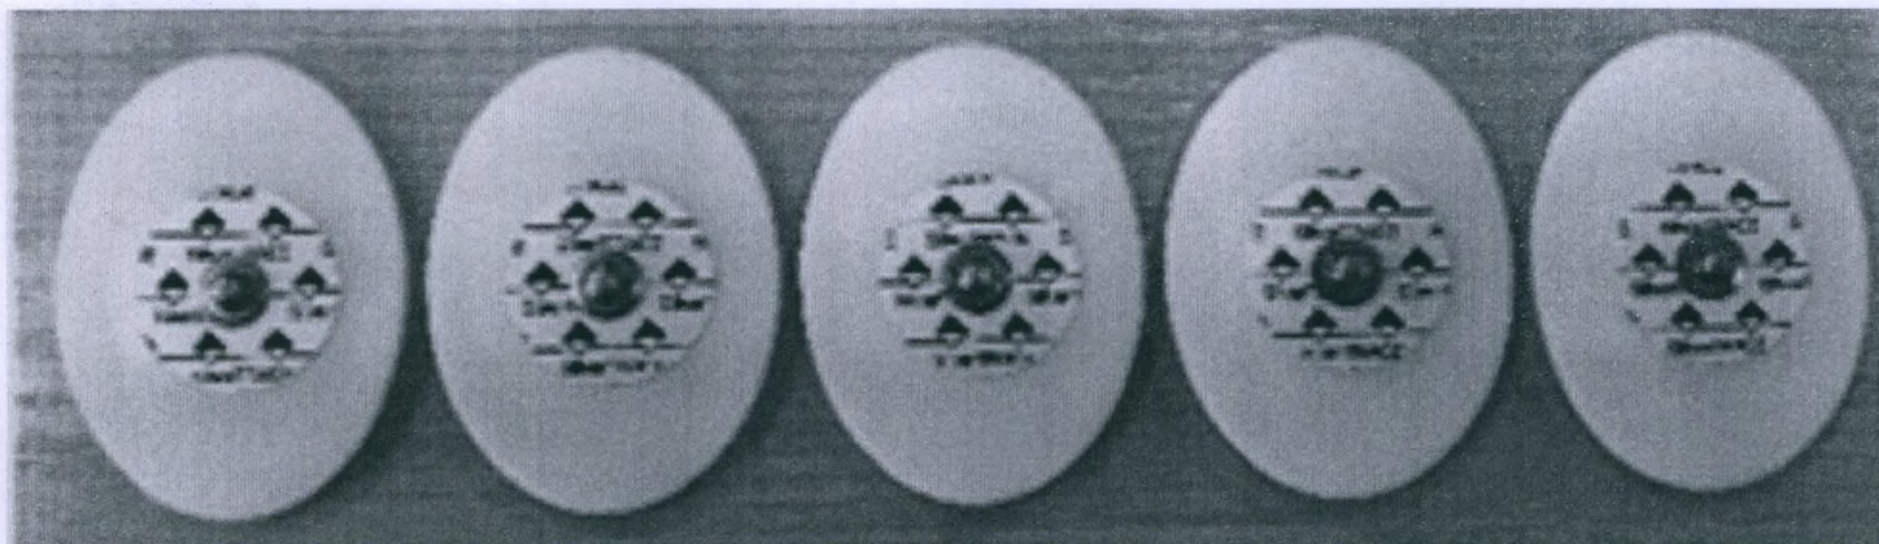


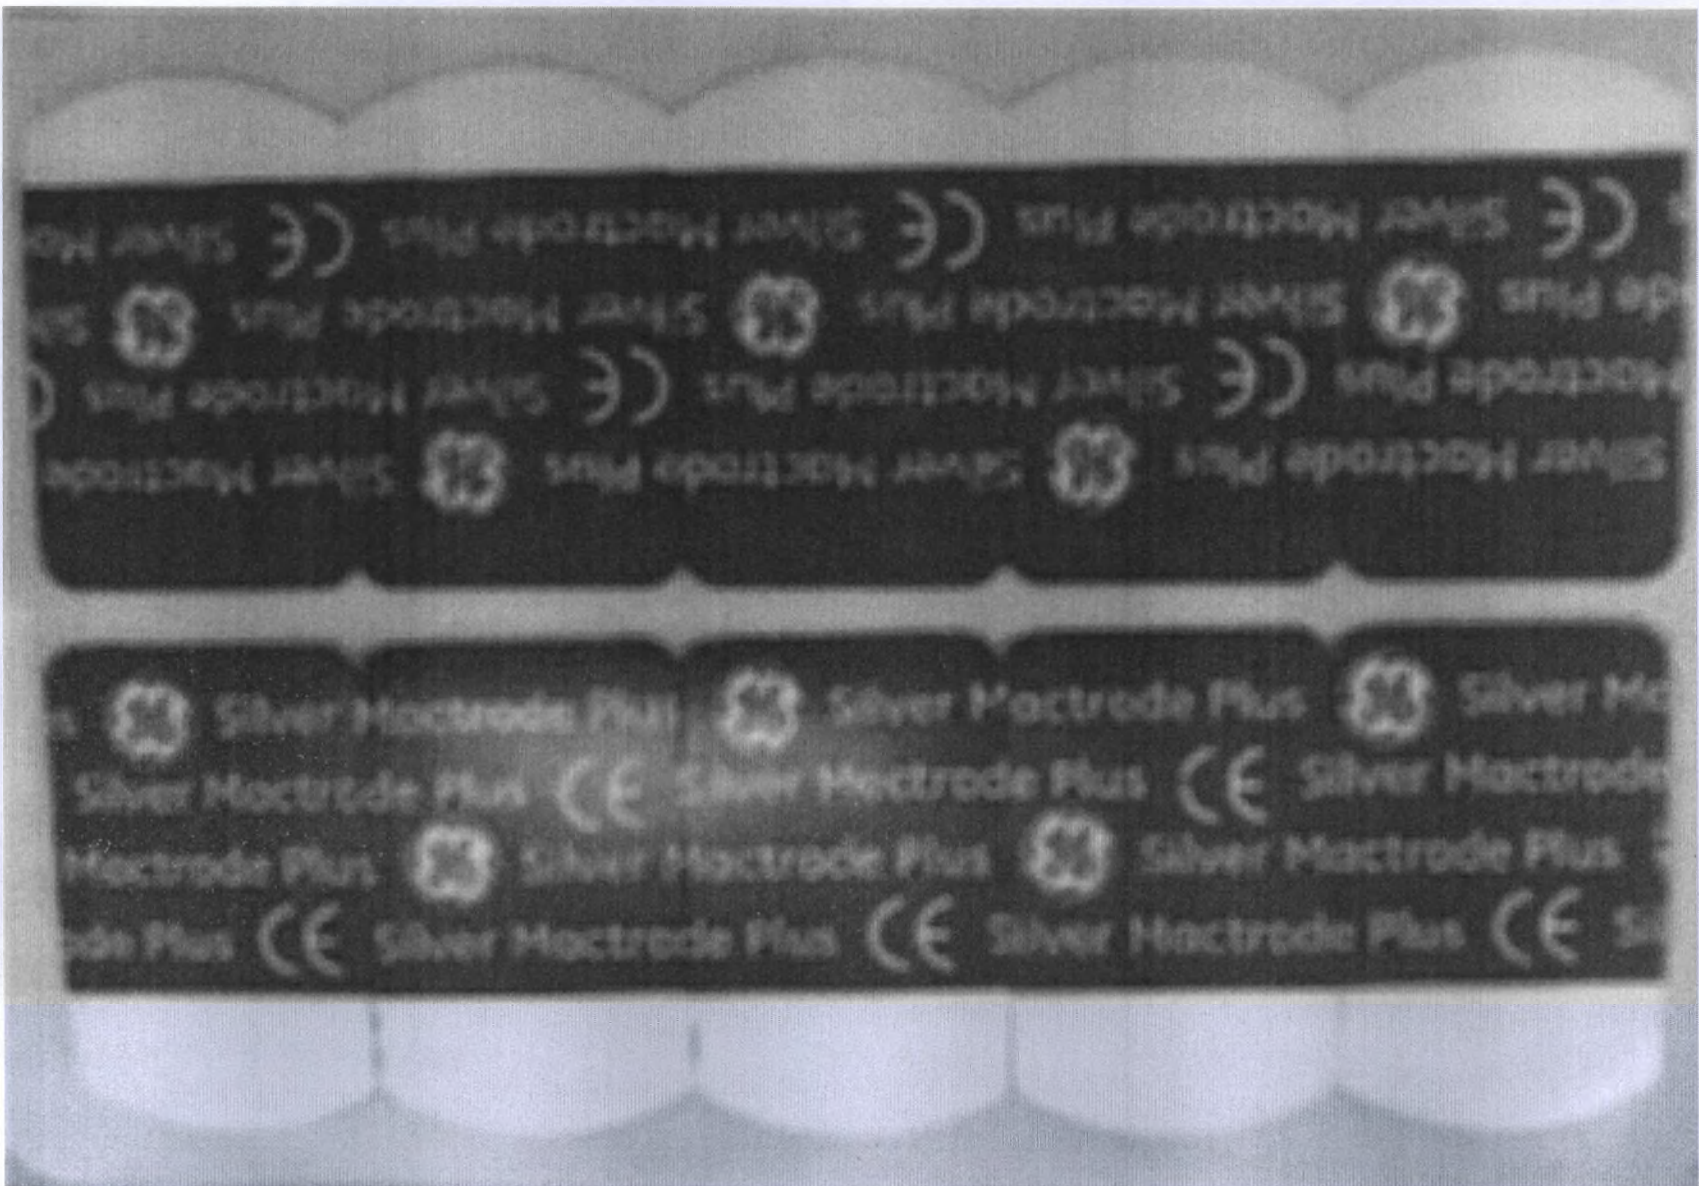

21. Многоразовый шаровой электрод Уэлша в форме груши (не более 50 шт.) (при необходимости).

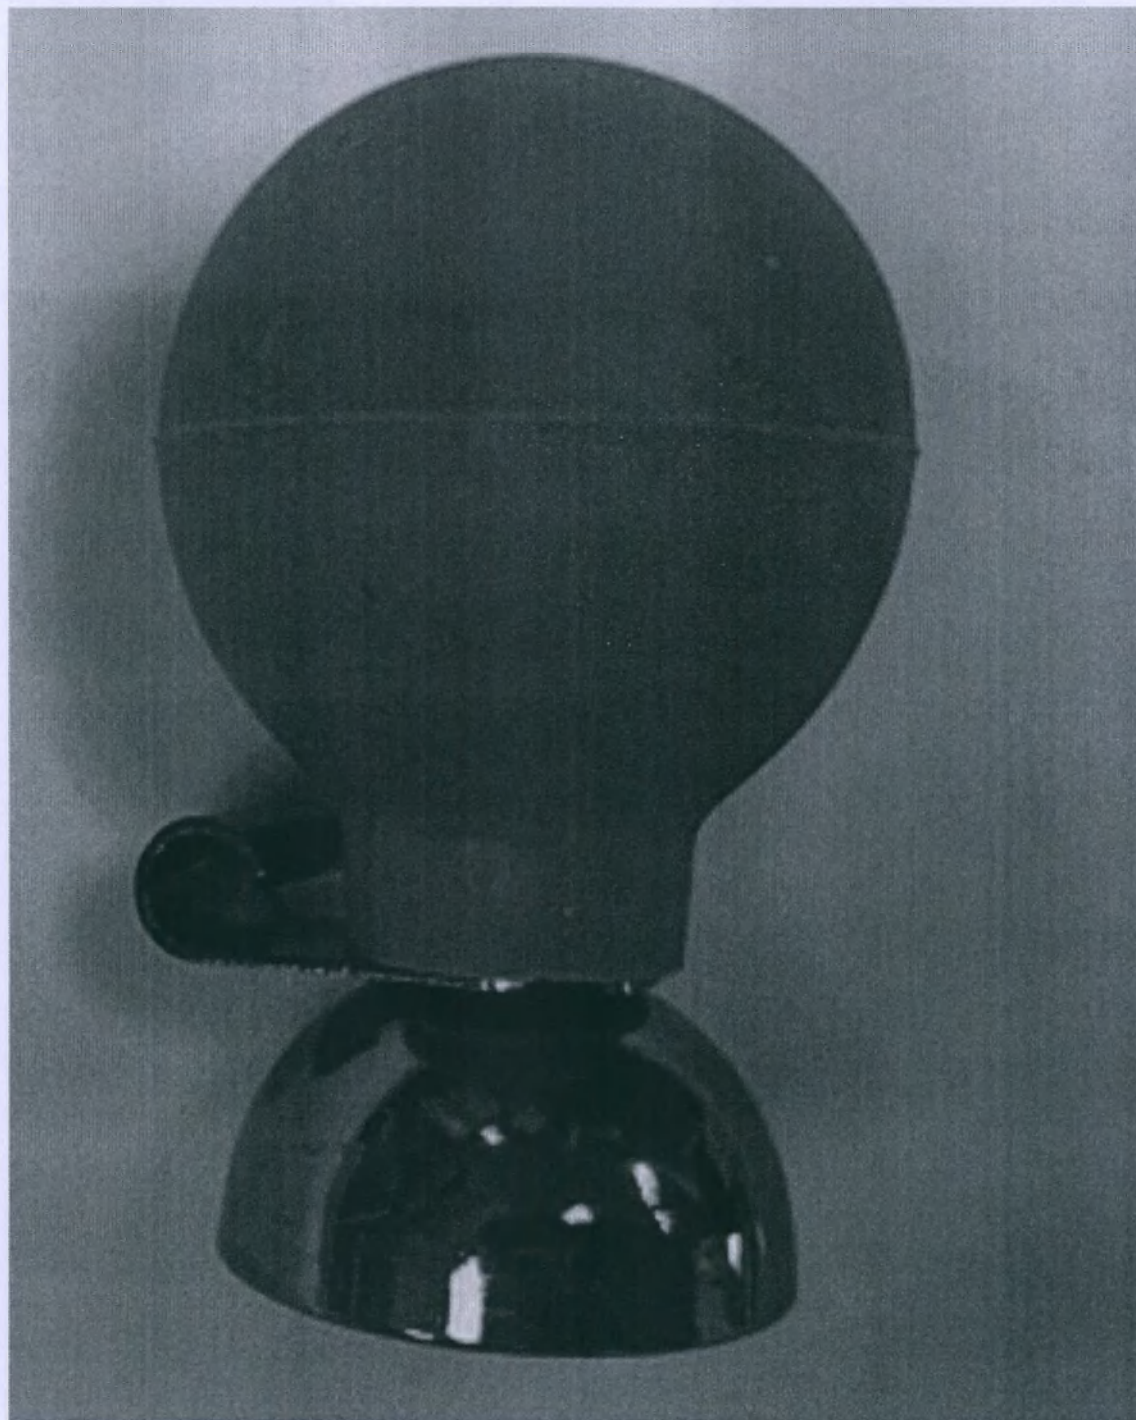

22. Многоразовый электрод в форме прищепки для конечностей (не более 50 шт.) (при необходимости).

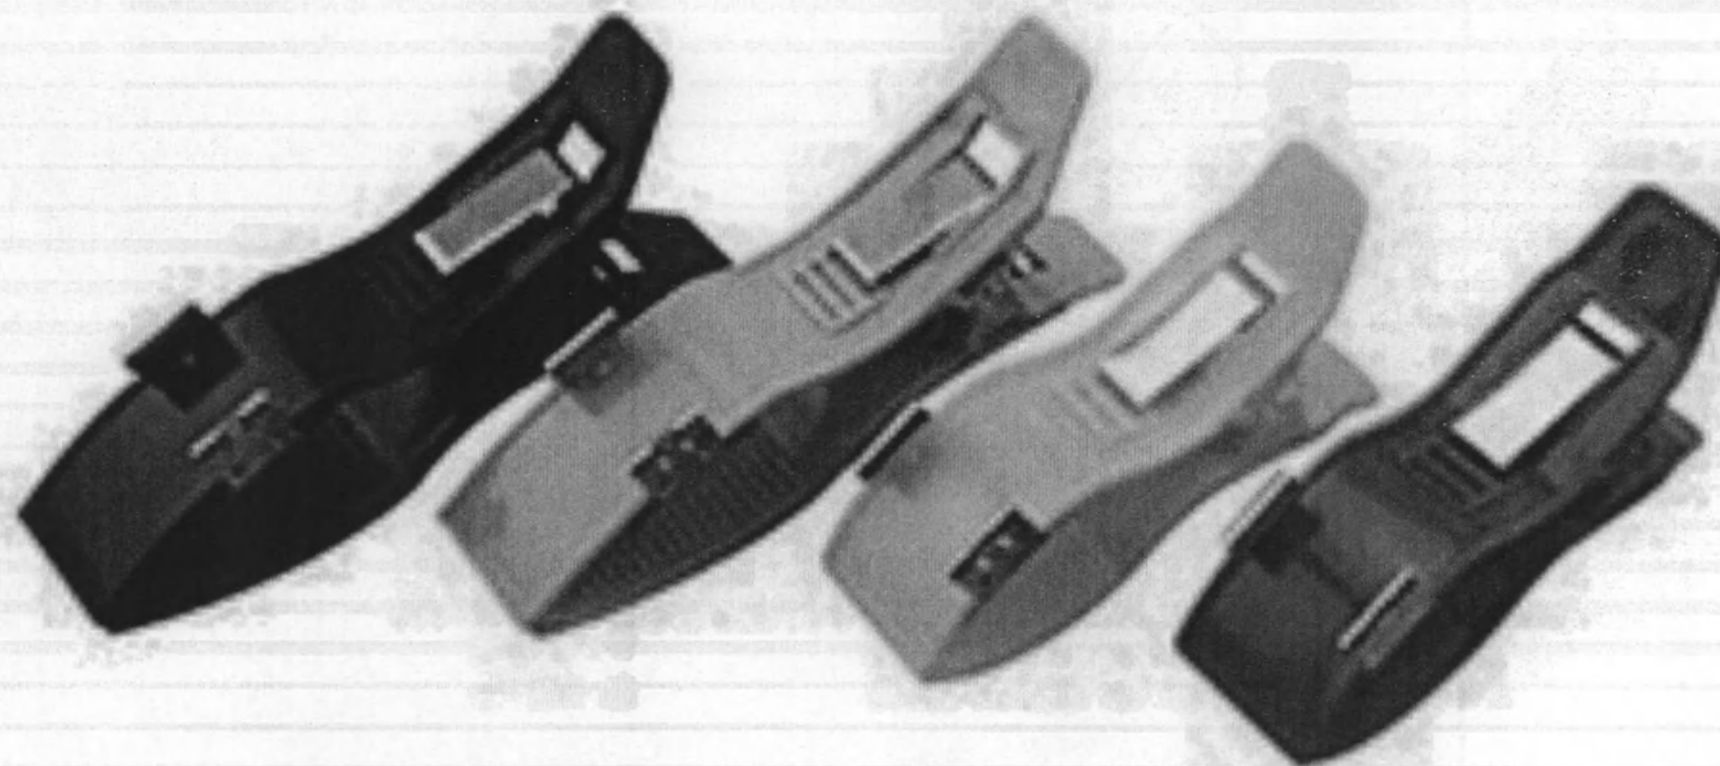


23. Устройство вакуумной аппликации без помпы (не более 2 шт.) (при необходимости).



24. Диск фильтра электрода для устройства вакуумной аппликации (не более 1000 шт.) (при необходимости)



25. Краткое справочное руководство по настройке (не более 5 шт.) (при необходимости).

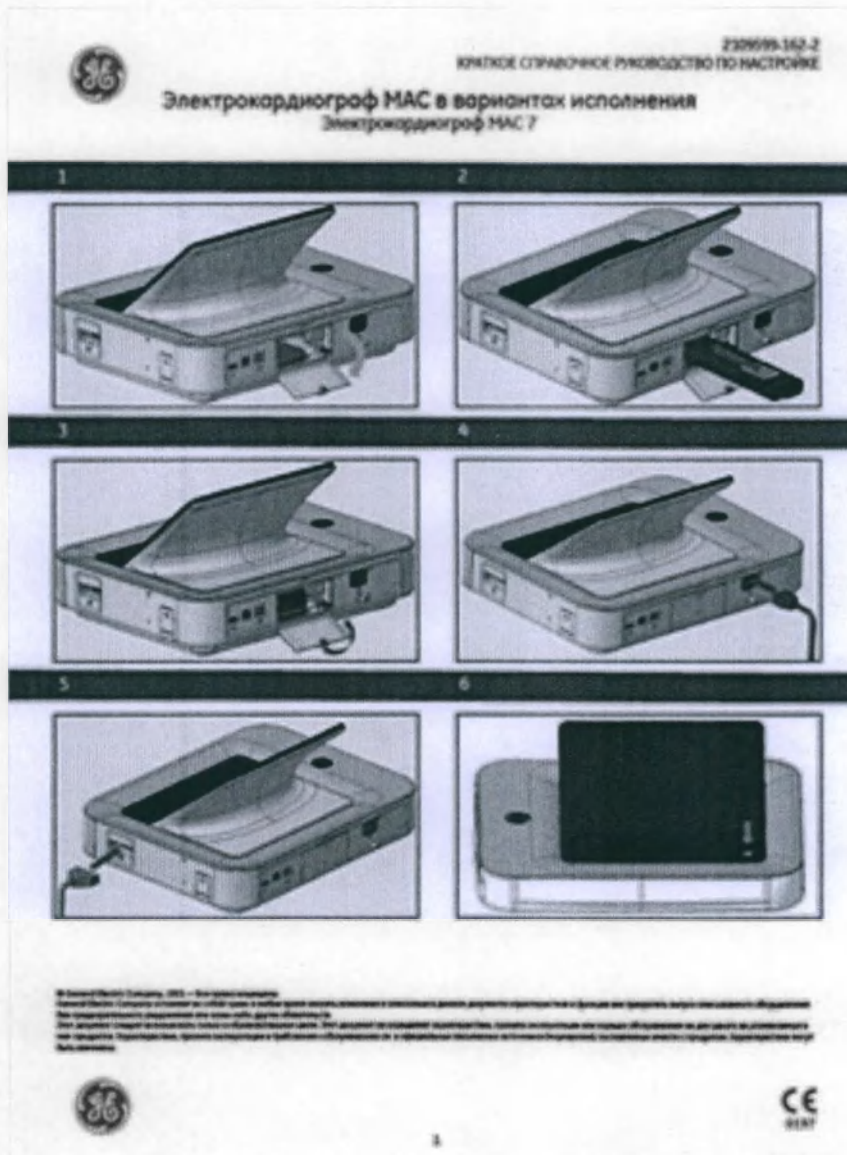



Электрокардиограф MAC в вариантах исполнения Электрокардиограф MAC 7

7109599-138-3
КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО

Вход в устройство

1. Введите имя пользователя и пароль на экране Login (Вход) или пользователя по умолчанию — Admin (Администратор). Пароль по умолчанию во время первого входа — admin123.
2. Установите пароль по умолчанию (Transfer your data from the system before you start the procedure (Перед началом процедуры перенесите свои данные из системы)).
3. Нажмите $\leftarrow$ на экране Login (Вход).
4. Введите серийный номер устройства в поле Enter the system serial number (Введите системный серийный номер).
5. Выберите Restore (Восстановить), чтобы устройство переустроилось. Вы можете получить доступ к устройству, используя имя пользователя и пароль по умолчанию.

Экран сбора данных

1. Вкладка Текущее изображение. Отображение кривой в реальном времени для текущего пациента, подключенного к устройству.
2. Вкладка Полная запись. Отображение полной записи ЭКГ.
3. Вкладка Информация о пациенте. Отображение информации о пациенте, такой, как имя, фамилия и пол.
4. Вкладка ЭКГ. Отображение сохраненной ЭКГ пациента.
5. Дата и время. Текущая дата и время в заданном формате.
6. Вкладка Сердечный ритм. Отображение сохраненного сердечного ритма пациента.
7. Вкладки Назначения/Пациент, файлы и Очередь. Выберите вкладку Назначения, чтобы открыть перечень назначений, выберите вкладку Файлы, чтобы открыть перечень файлов, выберите вкладку Очередь, чтобы открыть перечень очереди.
8. Пиктограмма яркости. Позволяет регулировать яркость экрана.
9. Пиктограмма с изображением батареи питания или питания от сети переменного тока. Показывает состояние батареи.
10. Пиктограмма состояния сетевого подключения. Показывает состояние беспроводного подключения или подключения через ЛВС.
11. Имя пользователя. Отображение имени пользователя, вошедшего в устройство.
12. Пиктограмма Запуск обследования нового пациента. Позволяет ввести сведения о пациенте для нового обследования пациента.
13. Пиктограмма Развернуть. Позволяет развернуть перечень на вкладках Заказы/Пациент, файлы или Очередь.
14. Изображения с разложением элктрода. Выберите стрелку, чтобы развернуть и просмотреть изображения.
15. Область уведомлений. Отображение сообщений, например, о состоянии печати и ходе процесса вывода на печать, в состоянии передачи отчета.
16. Индикатор качества сигнала, индикатор состояния качества отведения. Отображение индикатора общего состояния качества отведения.
17. Фильтр, скорость и коэффициент усиления. Отображение фильтра, скорости и усиления кривых по умолчанию.
18. Пиктограмма Запуск записи сердечного ритма. Позволяет начать запись или произвести запись отчета о сердечном ритме в цифровом виде.
19. Пиктограмма Запуск ЭКГ. Позволяет начать запись ЭКГ.
20. Лого отведения и формат отображения. Отображение типа теста и формата отображения по умолчанию.



GE Healthcare

Электрокардиограф MAC в вариантах
исполнения

Электрокардиограф MAC 7

Нормативные требования и техника безопасности

Версия 1


2109599-053-2


Постоянно храните данное руководство вместе
с руководством оператора и оборудованием,
периодически просматривайте его.



Электрокардиограф MAC 7
Нормативные требования и техника безопасности
Russian
© 2021-2022 General Electric Company
Все права защищены.

28. Кабели-электроды для наложения отведений при регистрации ЭКГ (не более 50 шт.) (при необходимости).

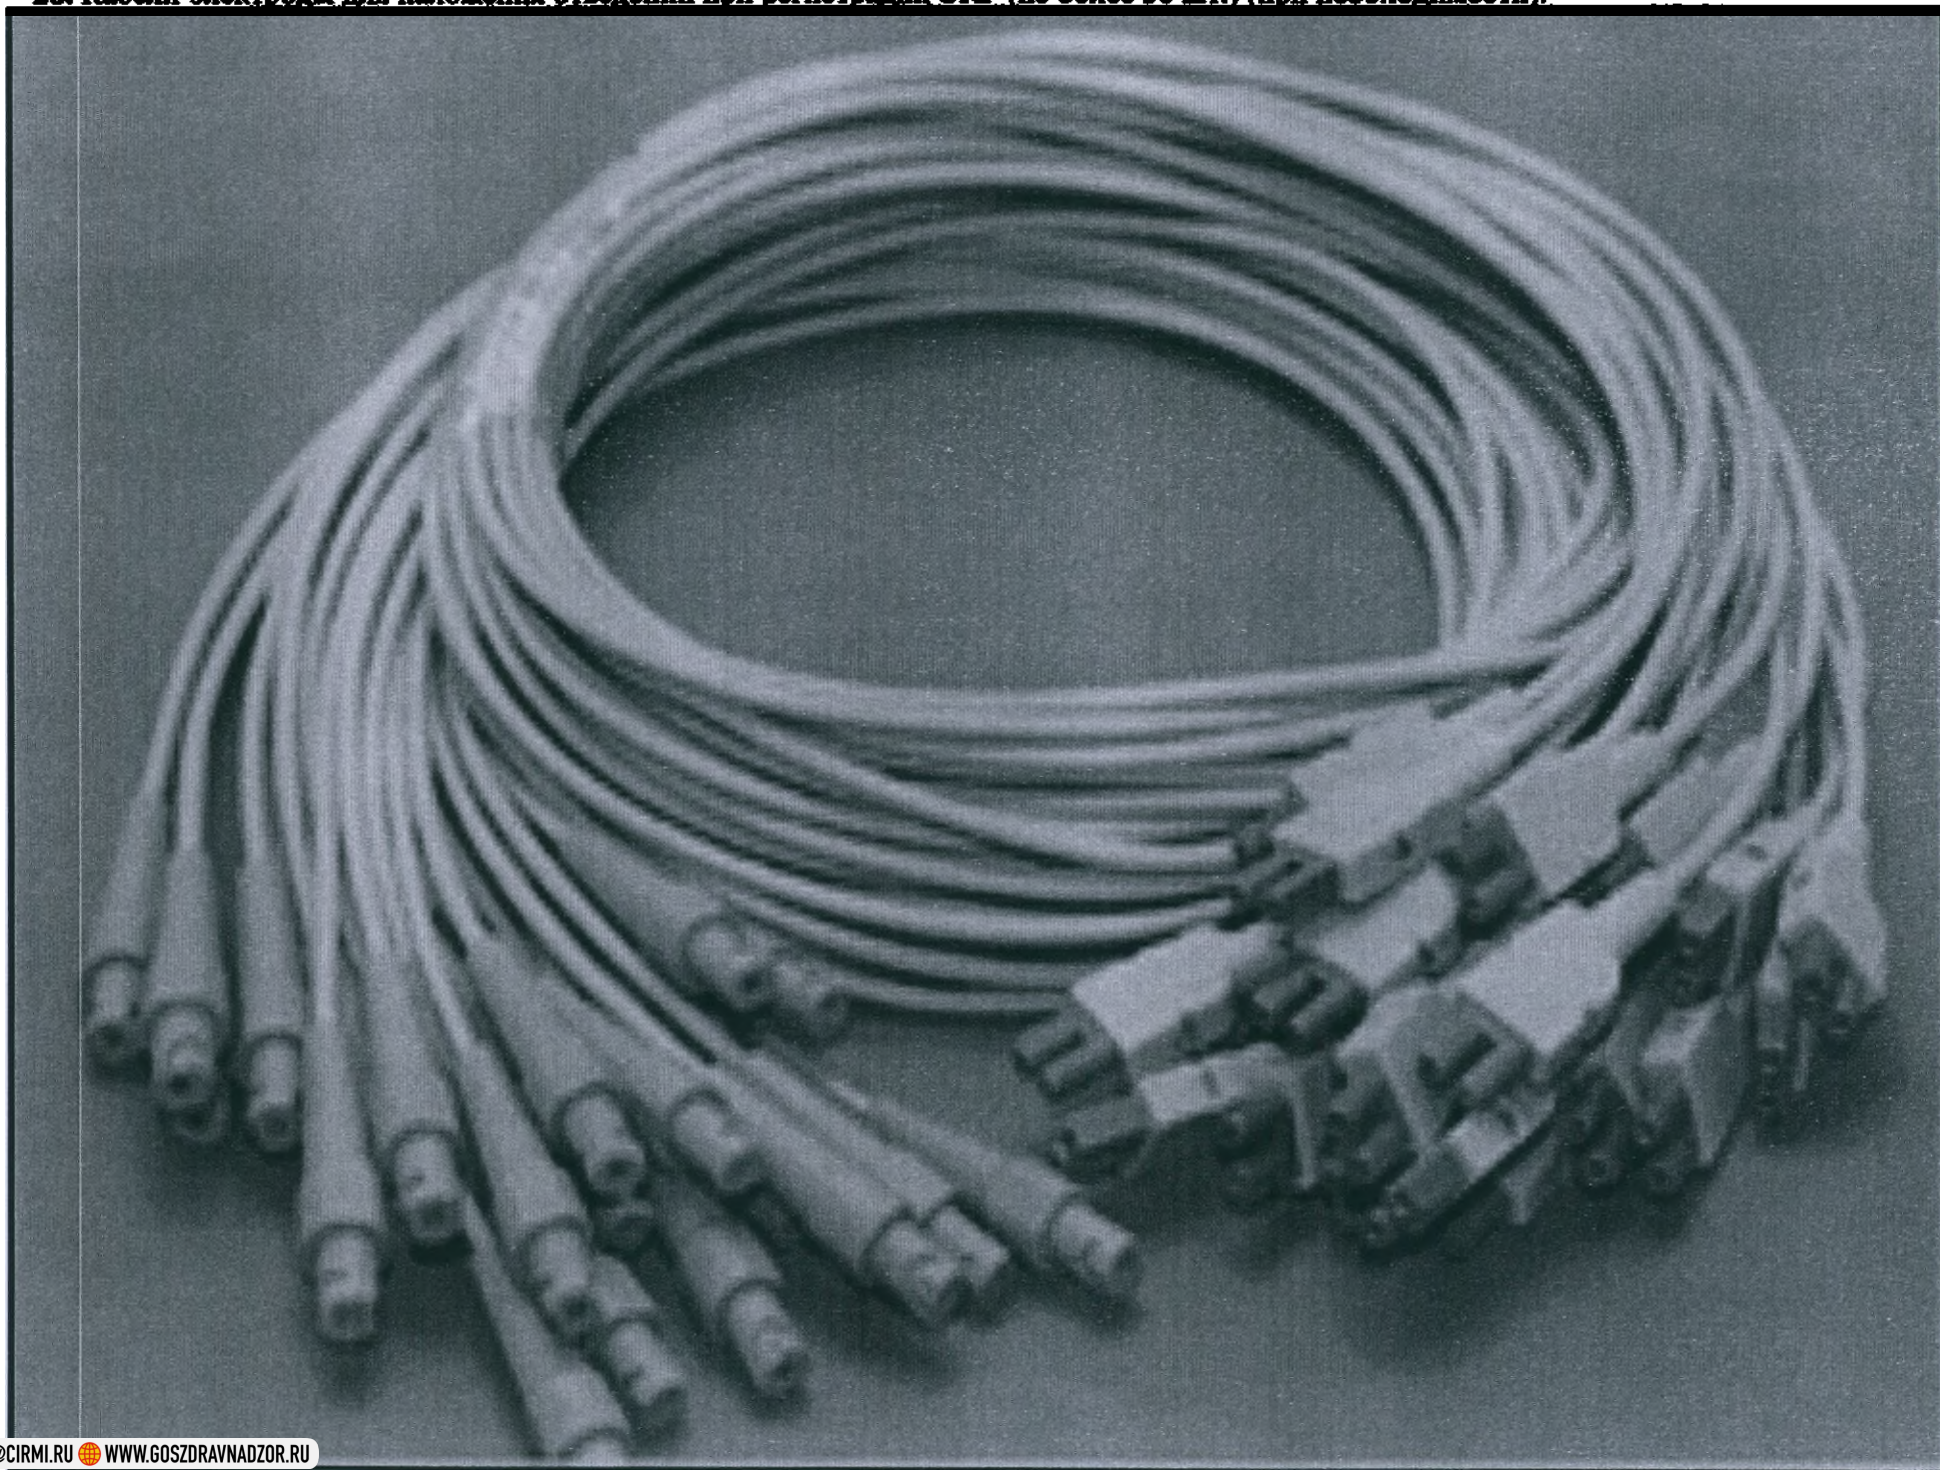

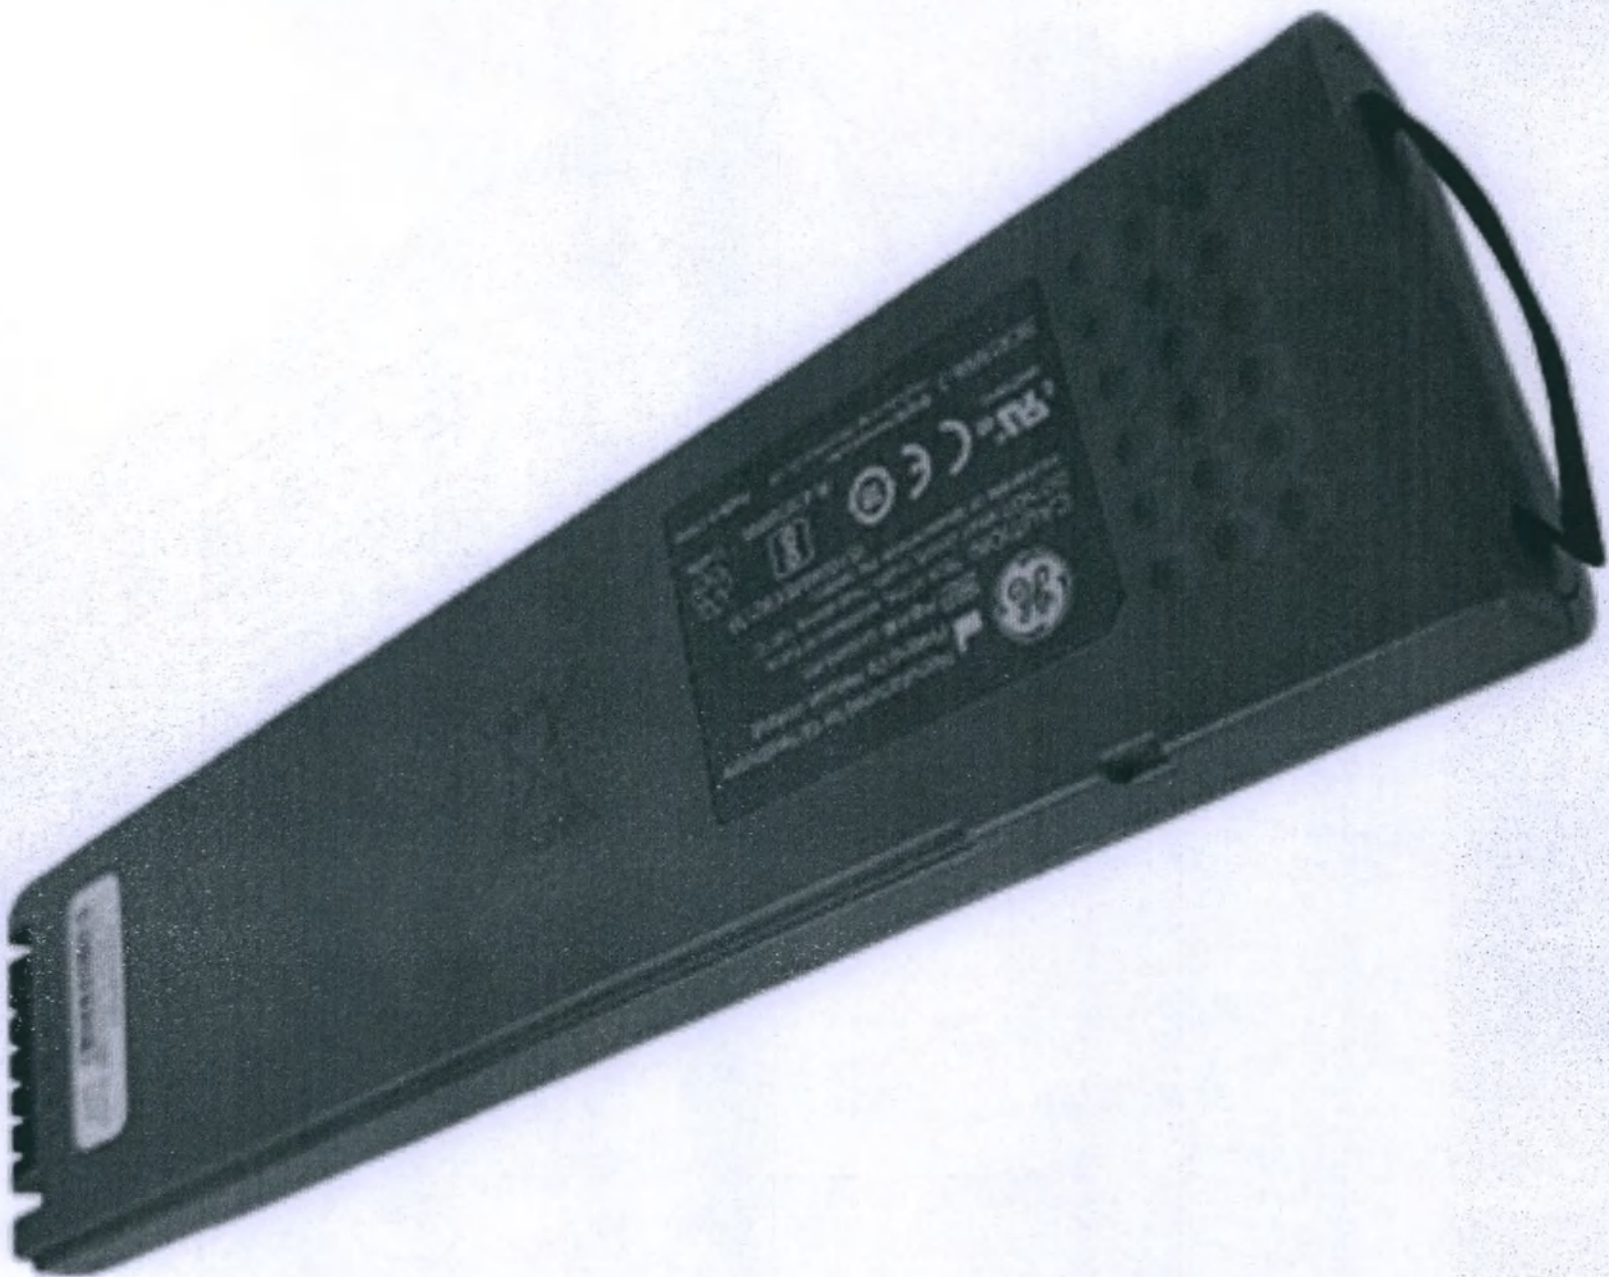


Примечание: 1. Аккумуляторная литий-ионная батарея (не более 5 шт.)


2. Сумка переносная для электрокардиографа с карманами для аксессуаров (не более 10 шт.)



3. Специальная термочувствительная бумага для распечатки ЭКГ (не более 3000 пач.)

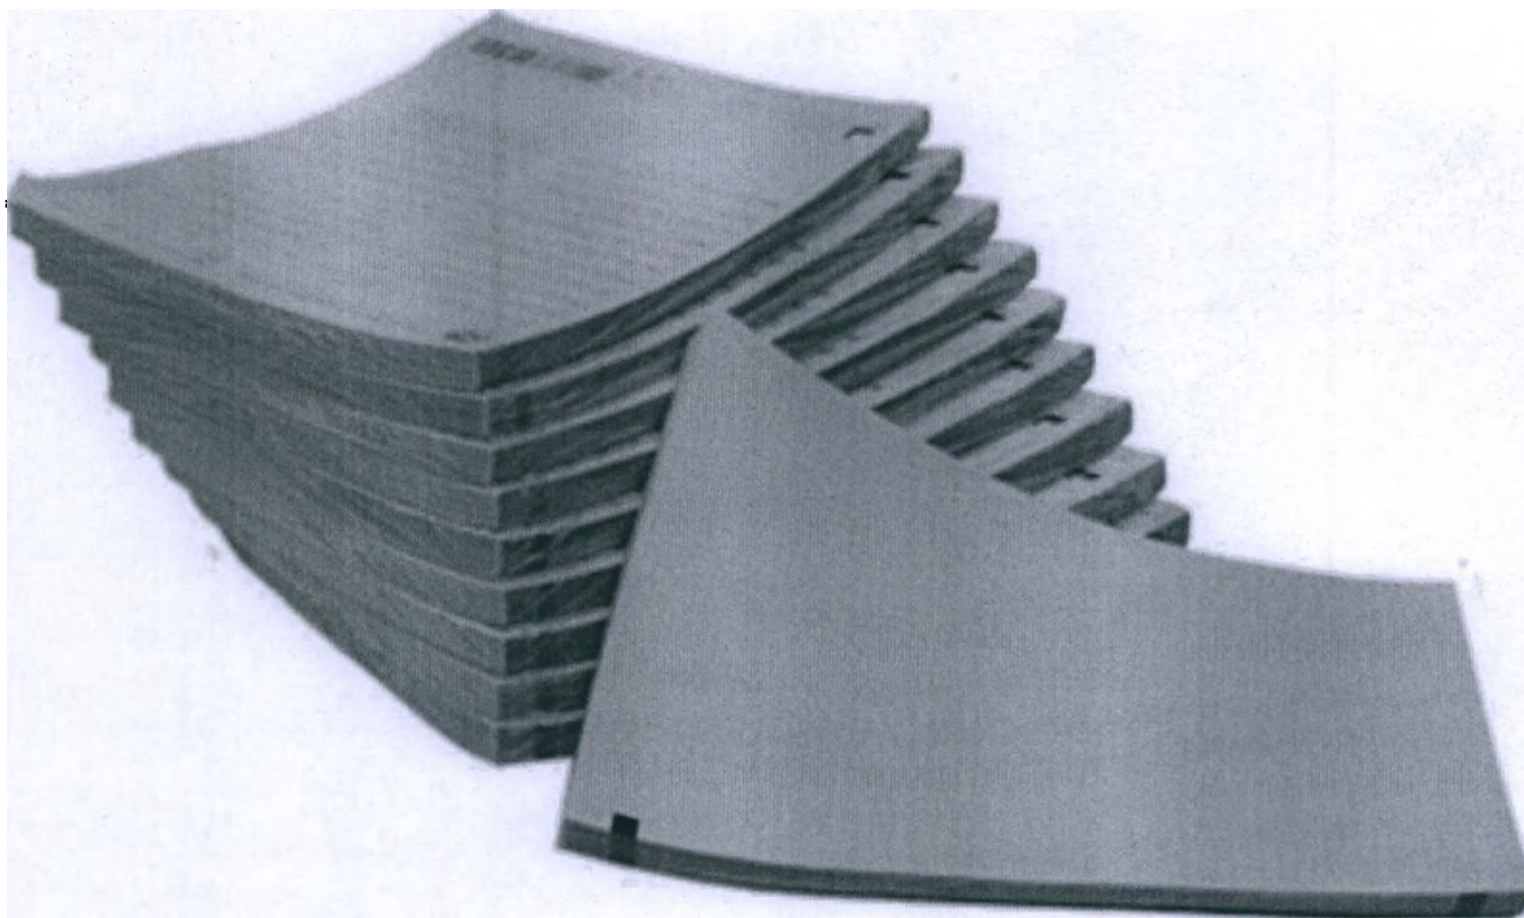

4. Термочувствительная бумага для распечатки ЭКГ (не более 1000 шт.)

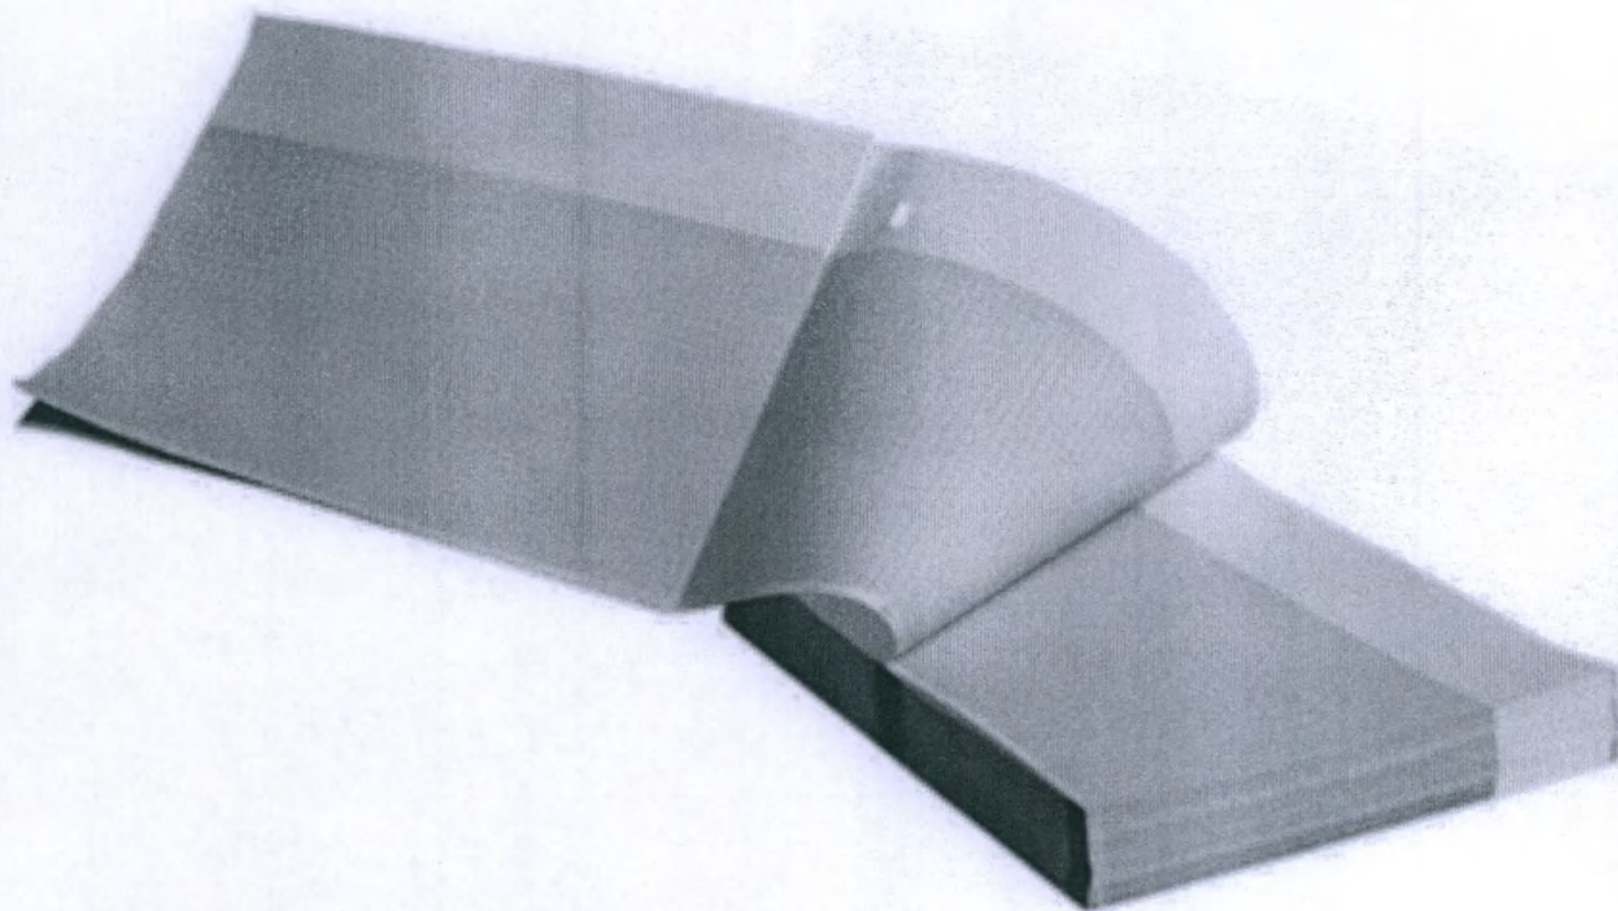

5. Кабель сетевой типа Ethernet для подключения к локальной сети. (неб более 5 шт.)





6. Оптический или электронный носитель с документацией.


7. Лицензионный ключ для ПК.




8. Лицензионный ключ для ПК.




9. Материнская плата электрокардиографа с электронными компонентами, производитель GE Medical Systems Information Technologies, Inc., США.

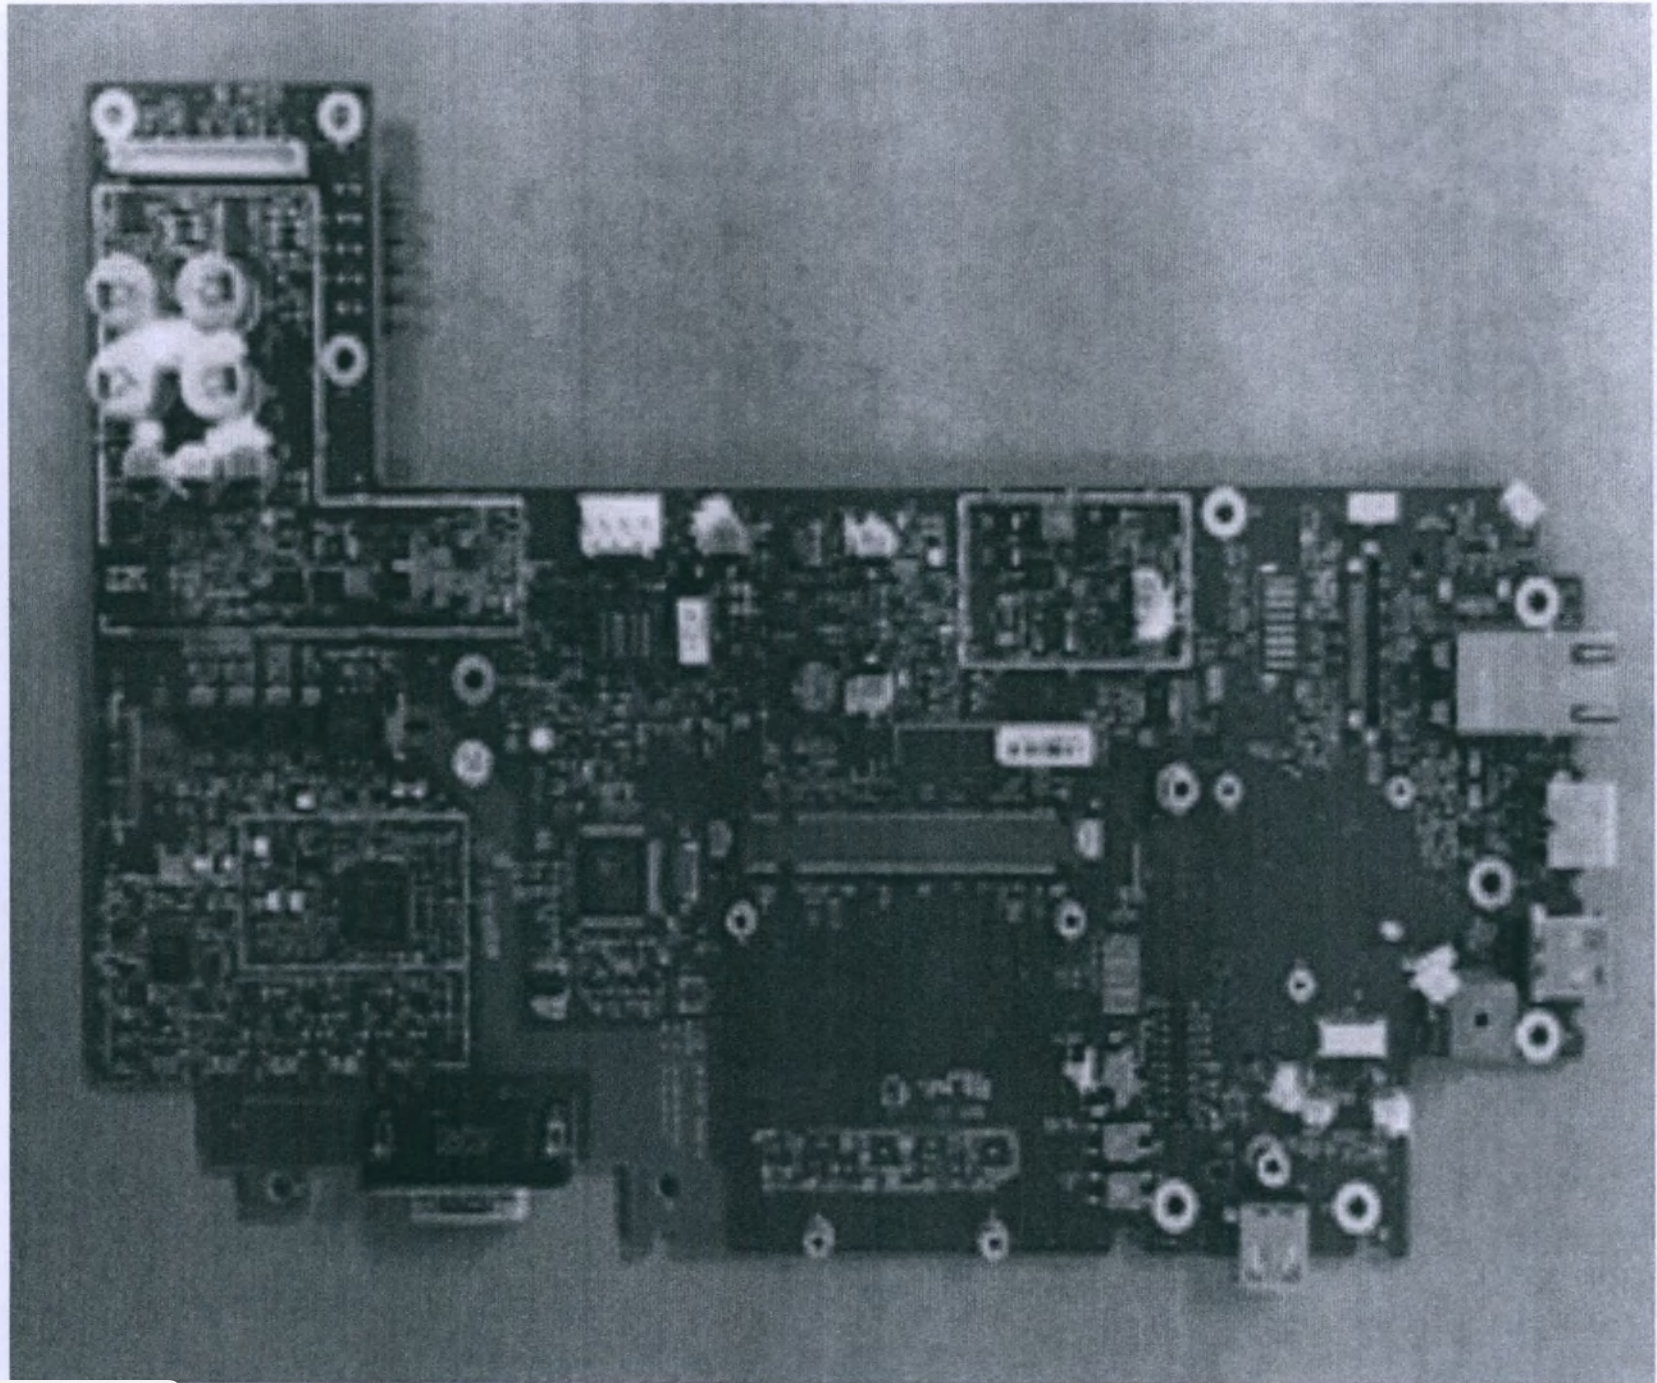

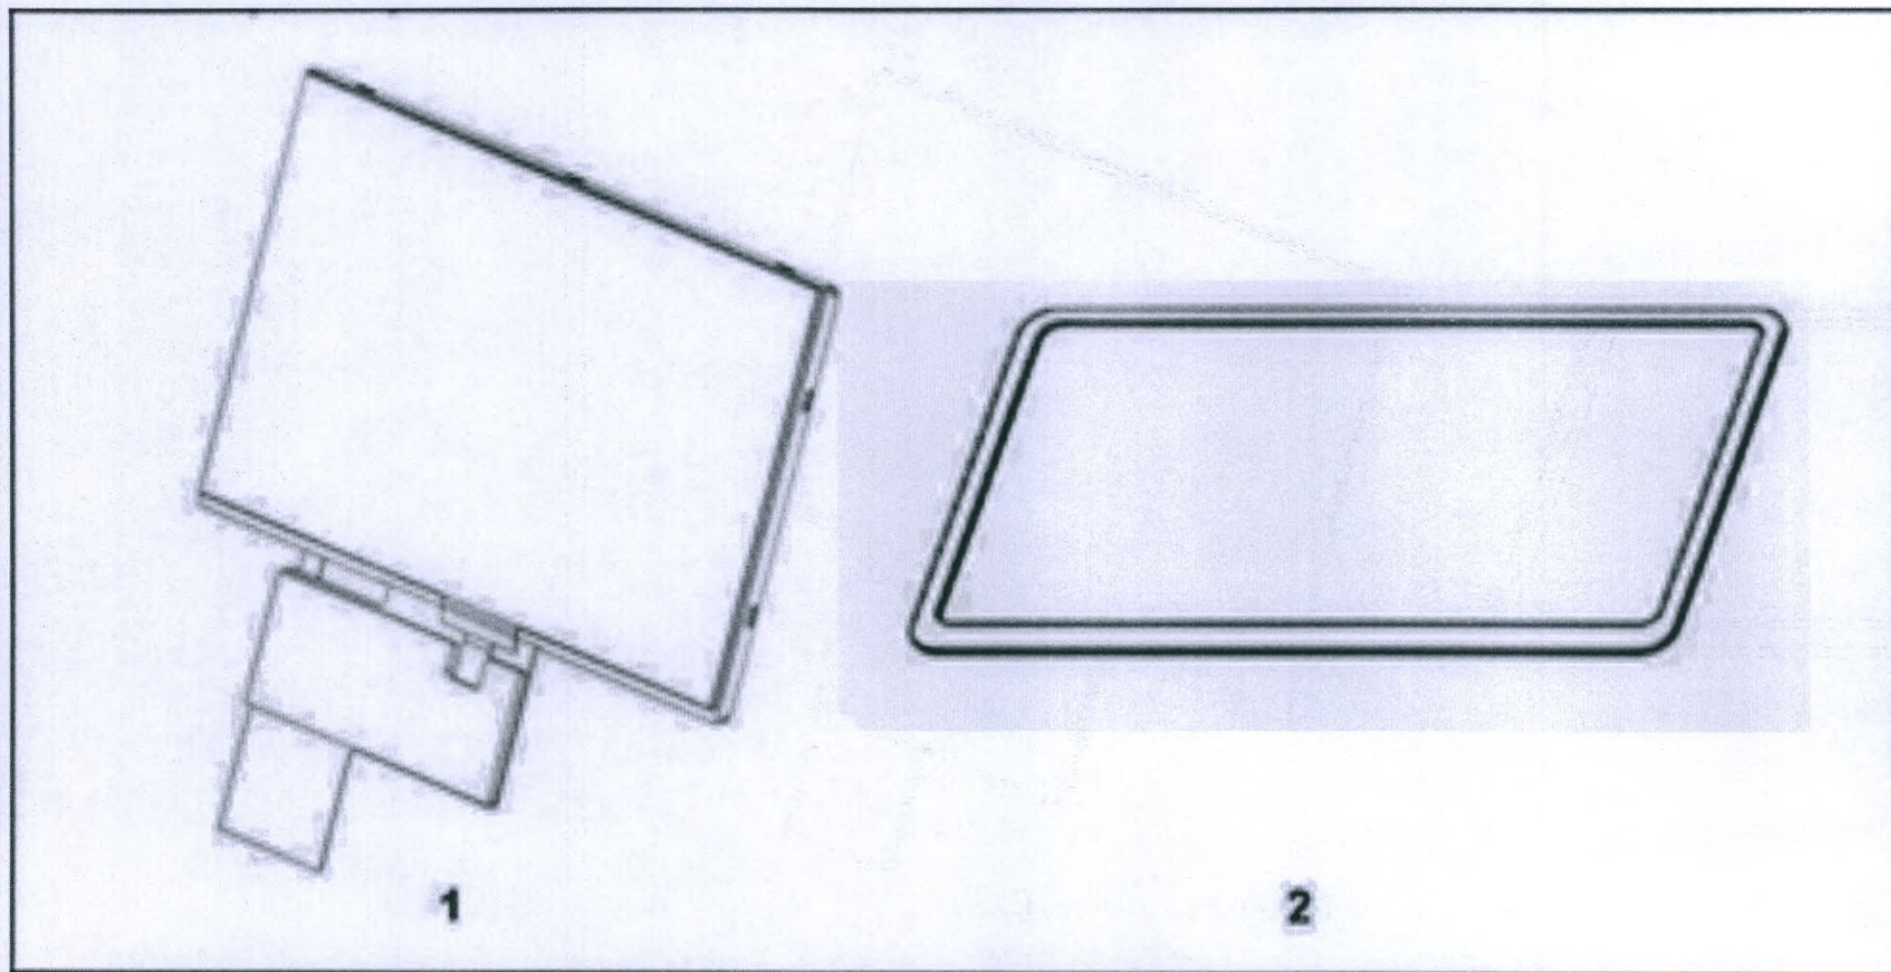


11. Тележка для электрокардиографа.

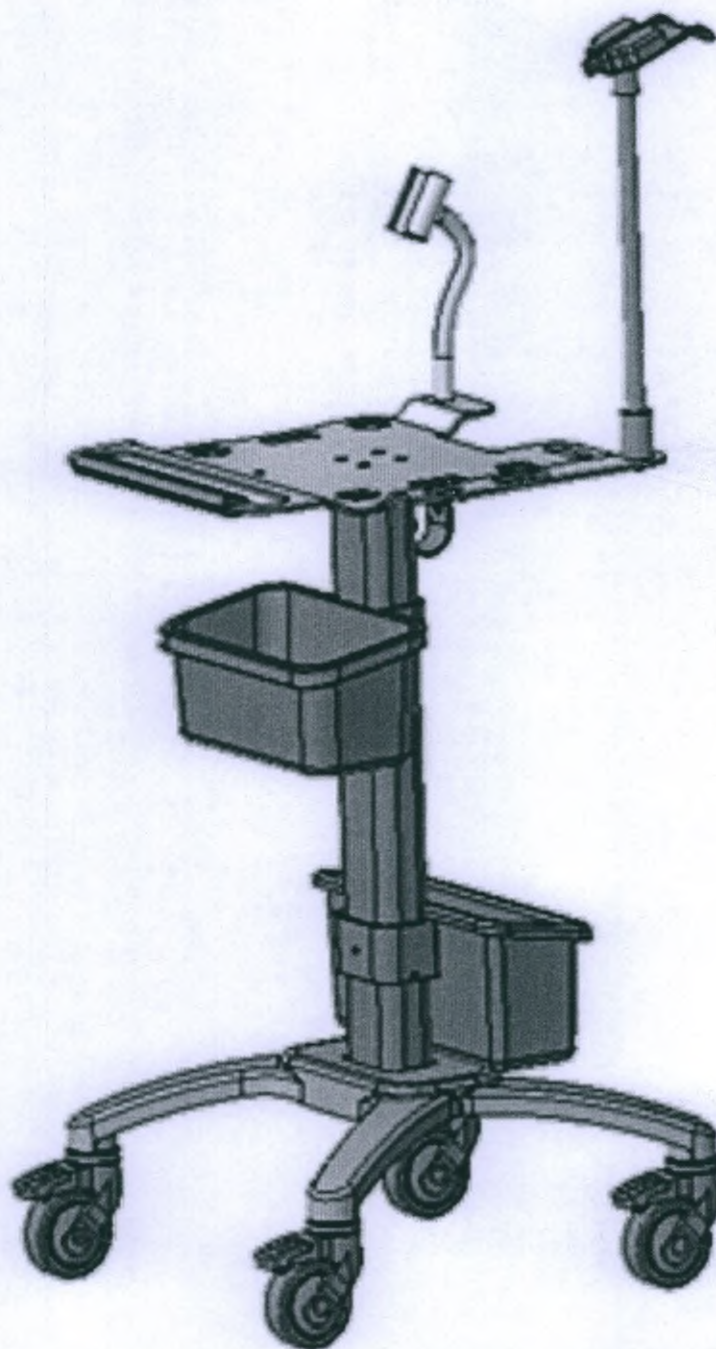


12. Держатель кабеля пациента для тележки.



13. Держатель для устройства чтения штрих-кодов.

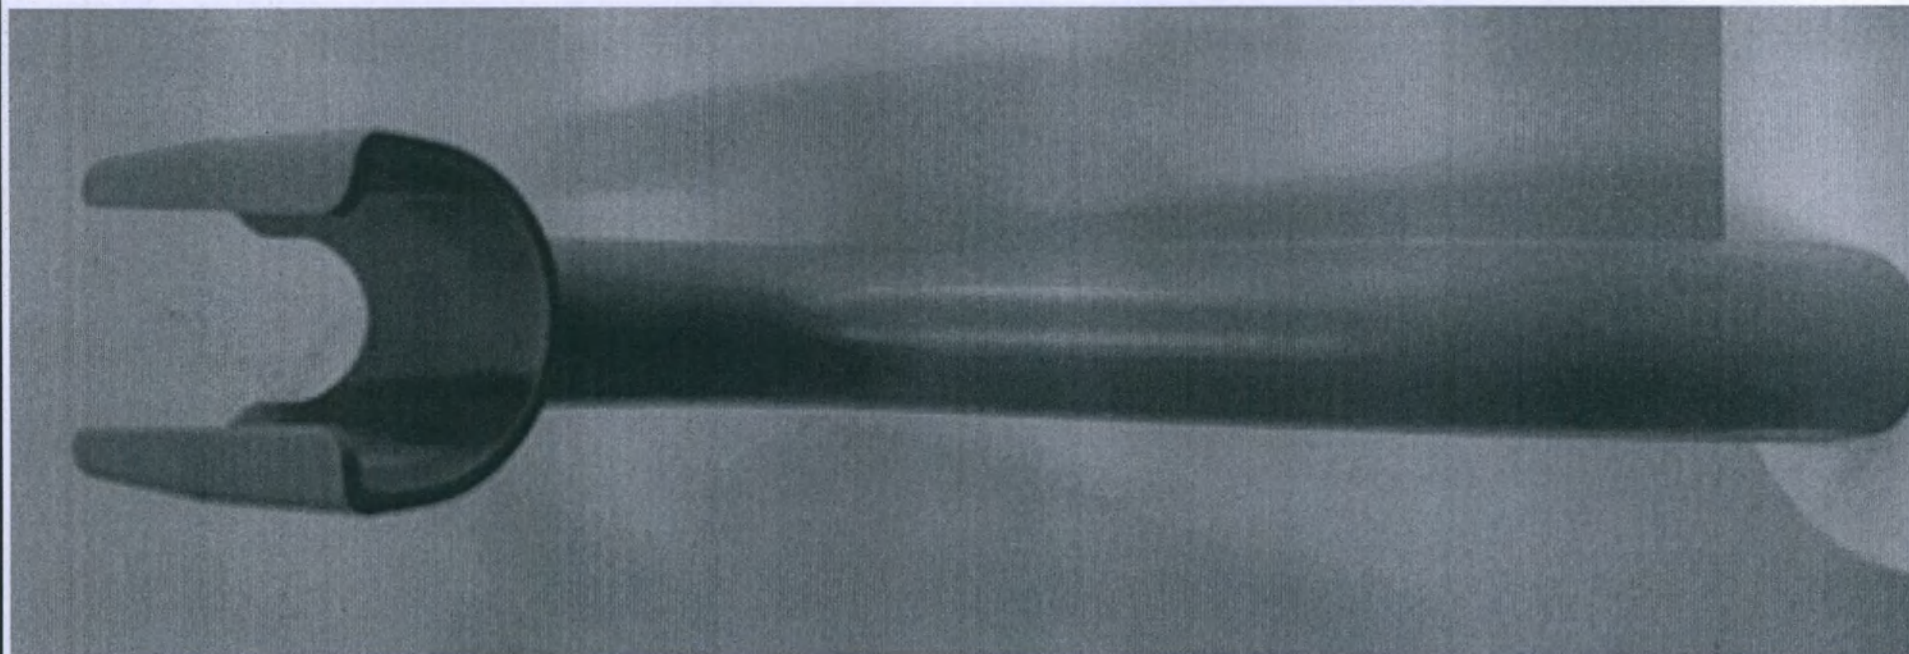

14. Держатель кабелей для фиксации на тележке.

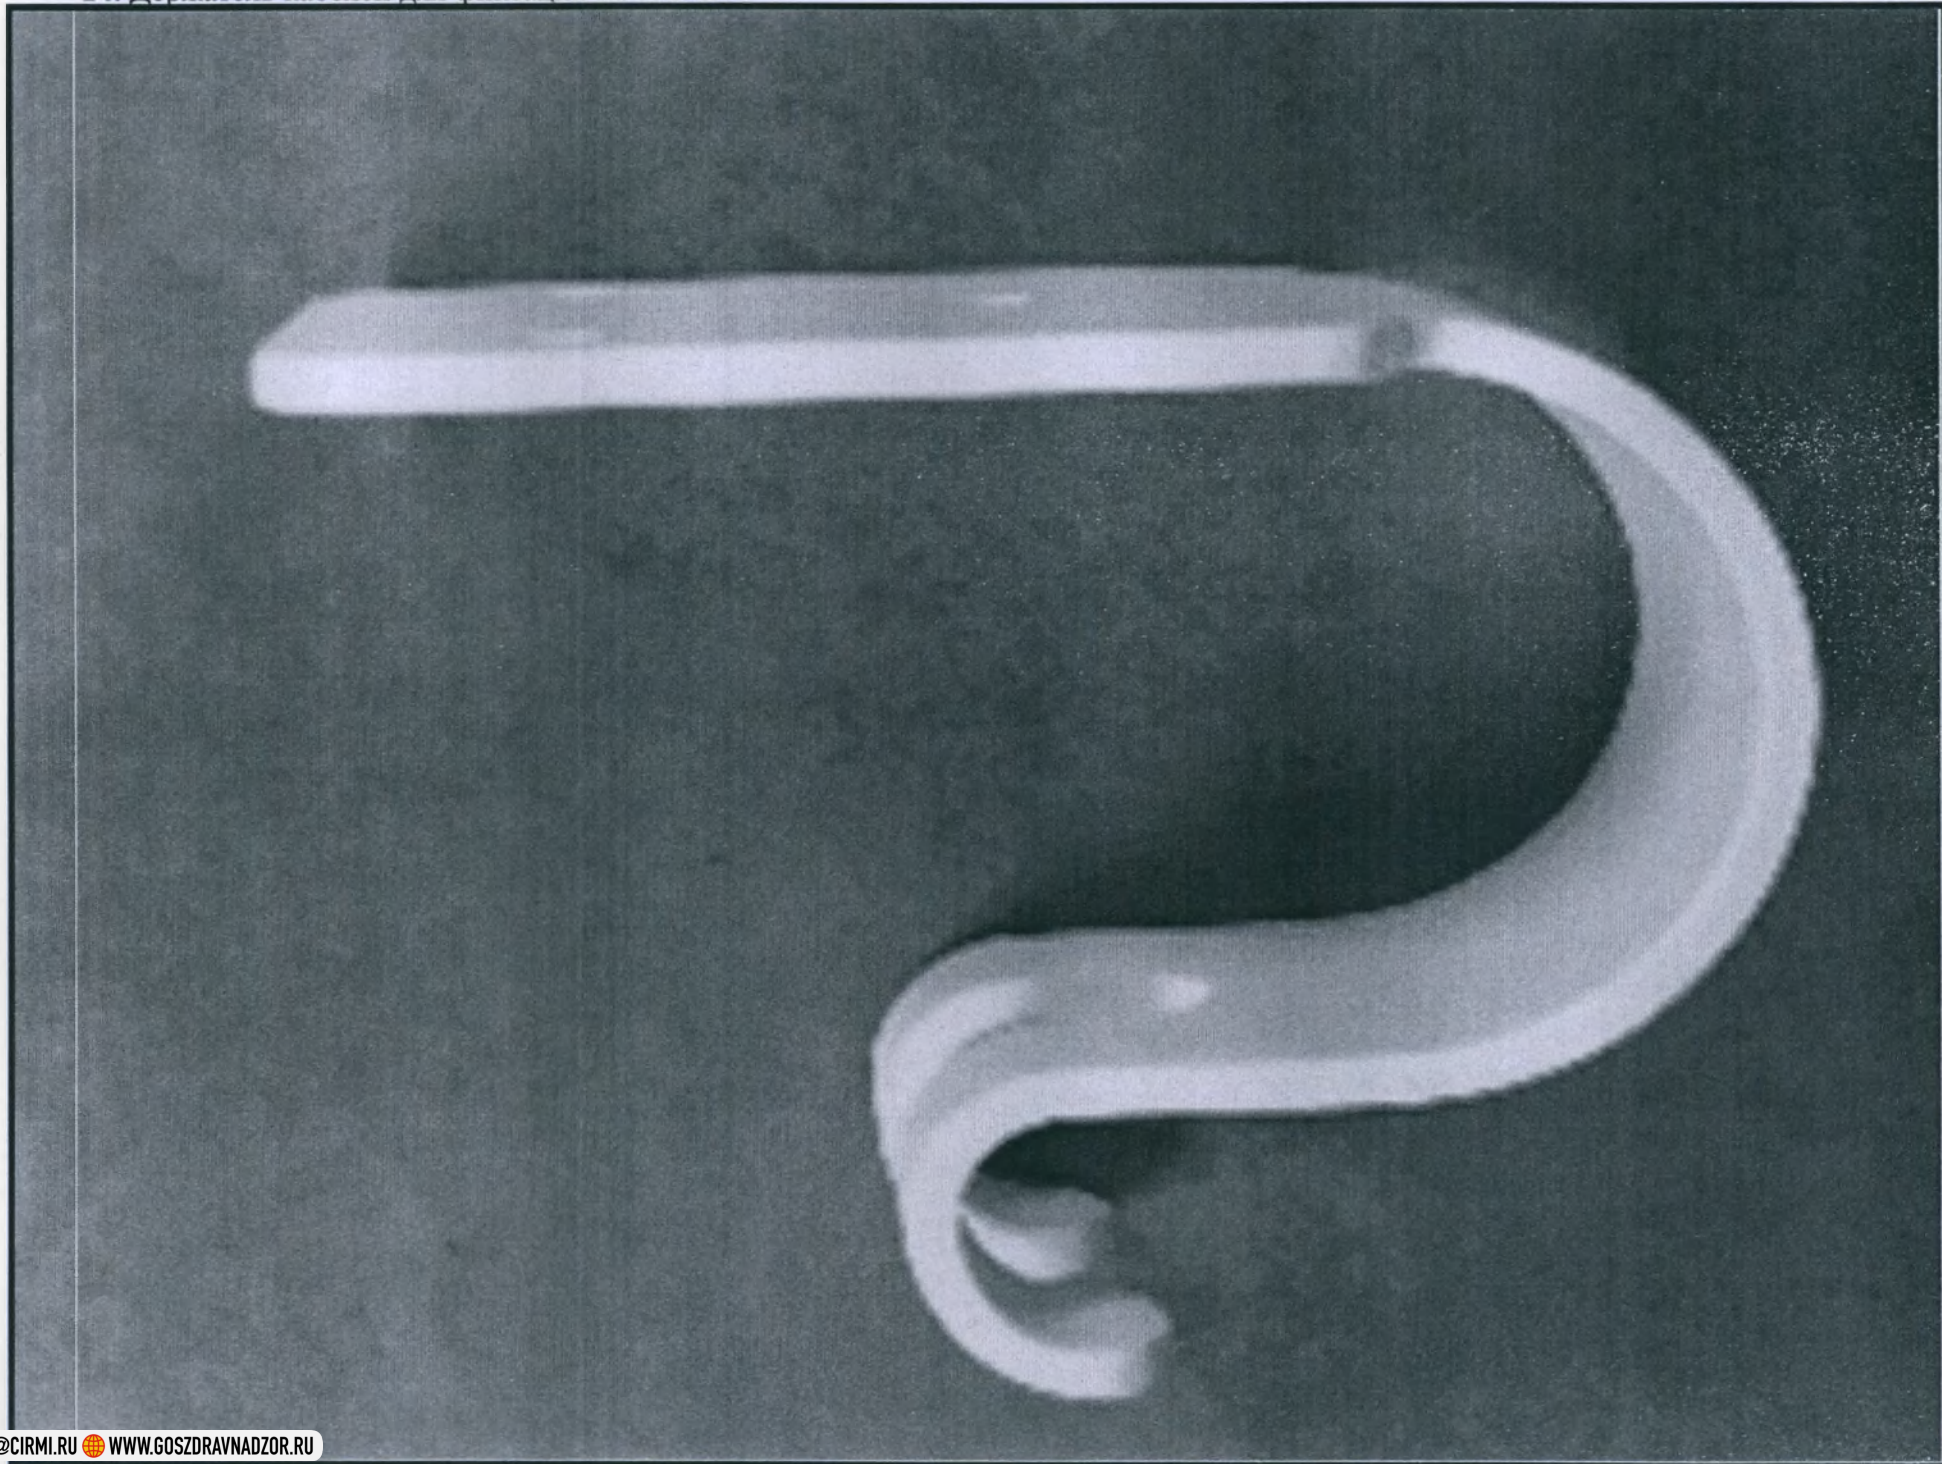


15. Корзина для тележки (не более 2 шт.)






16. Крепление к столу для электрокап/инотера (не более 30 шт.).


17. Кабель для подключения системы вакуумной аппликации электродов (не более 2 шт.)

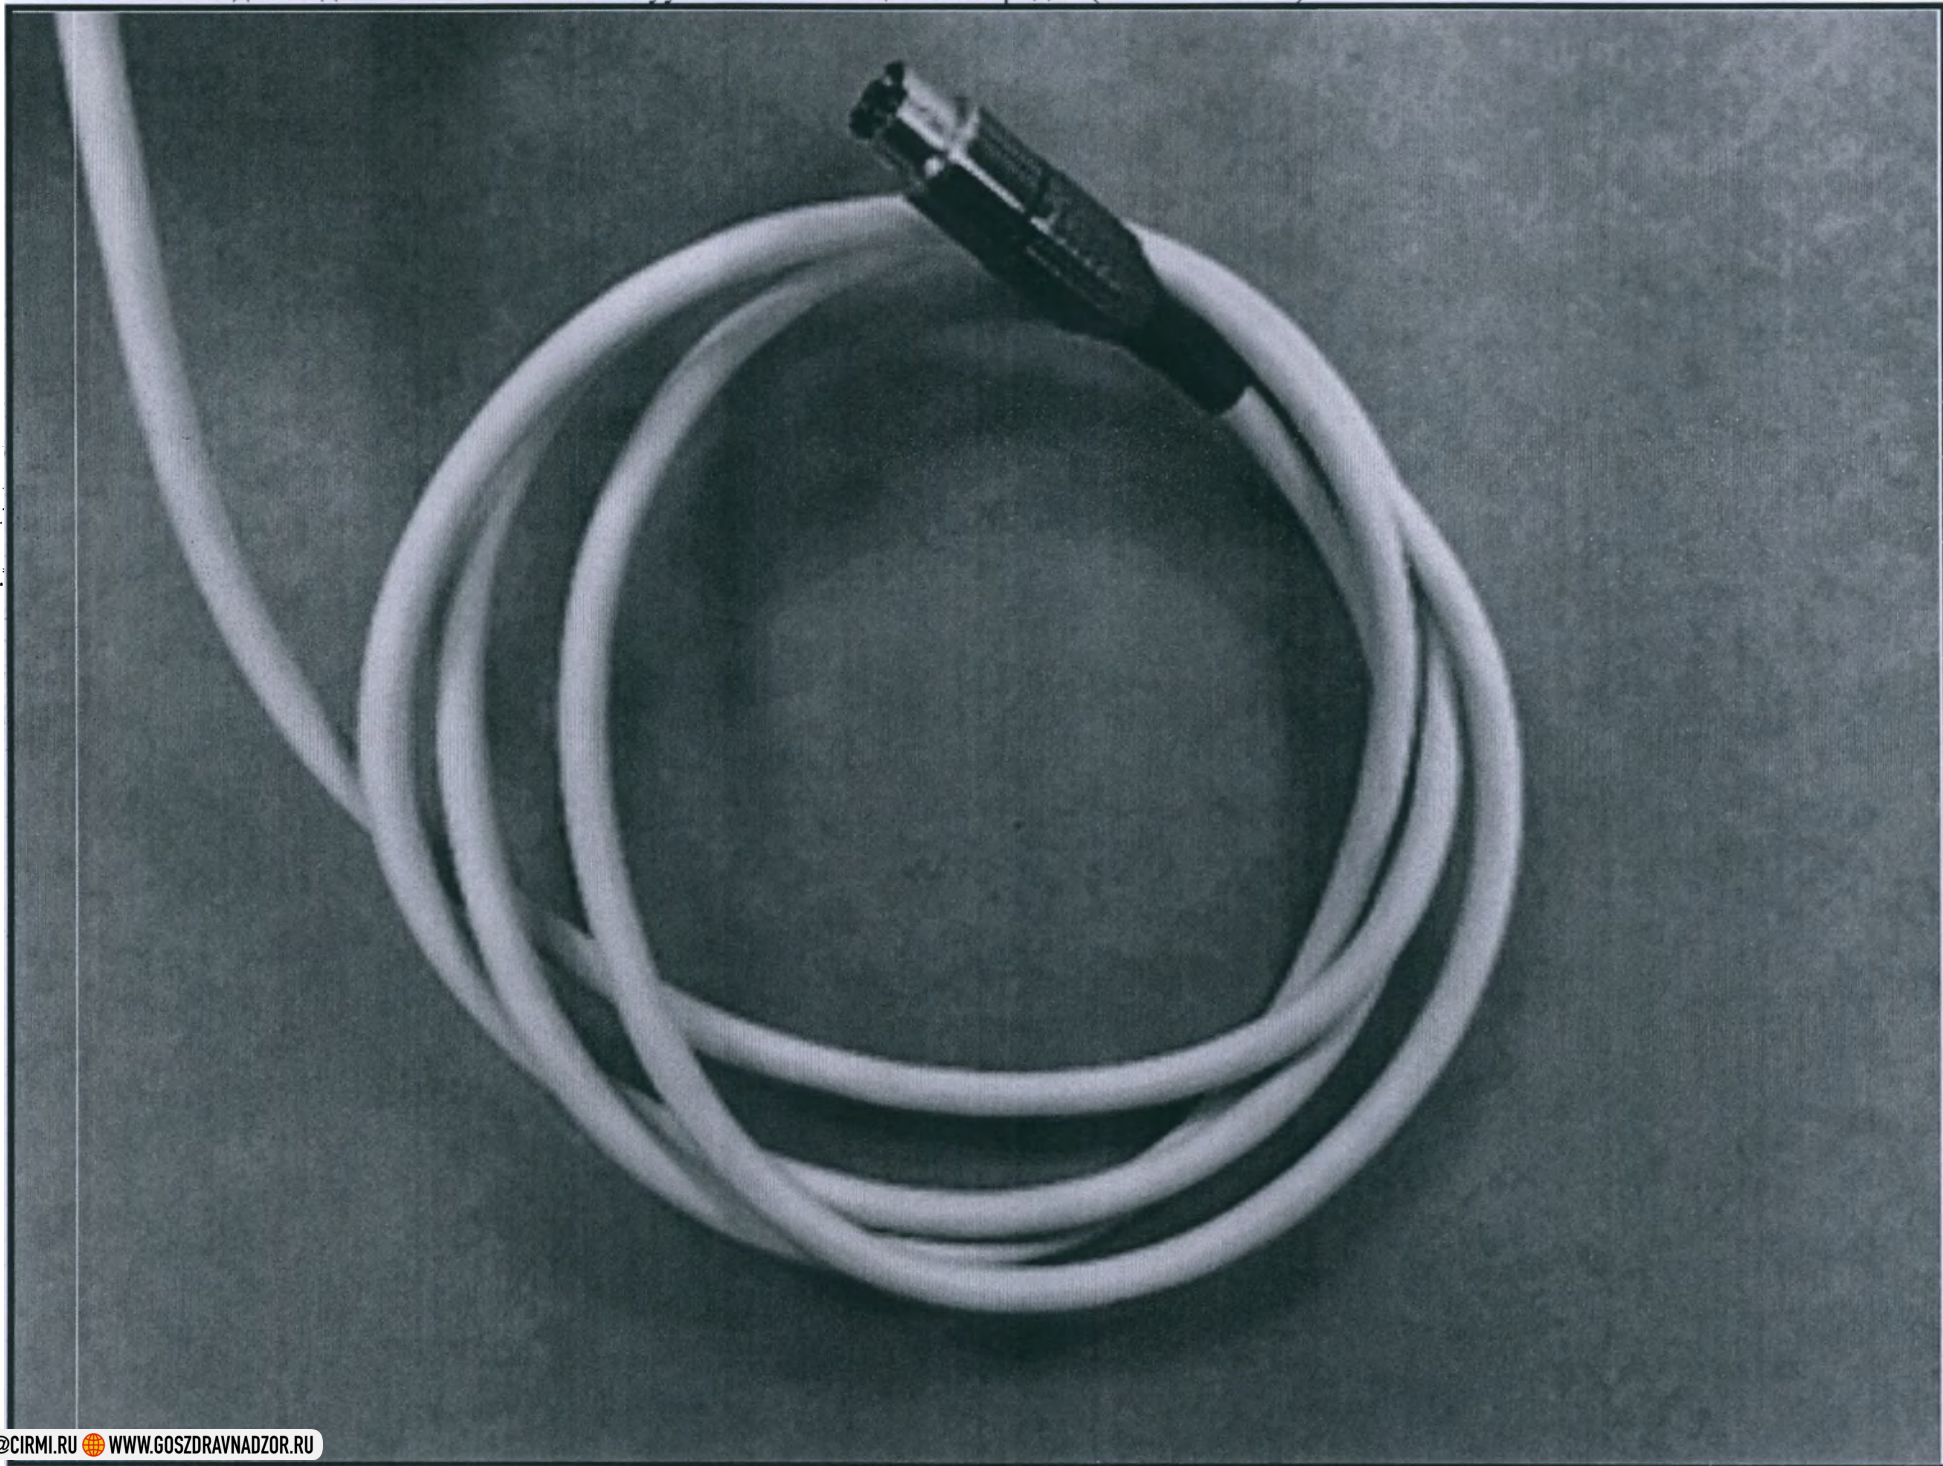


18. Помпа для системы вакуумной аппликации электродов в сборе (не более 2 шт.).

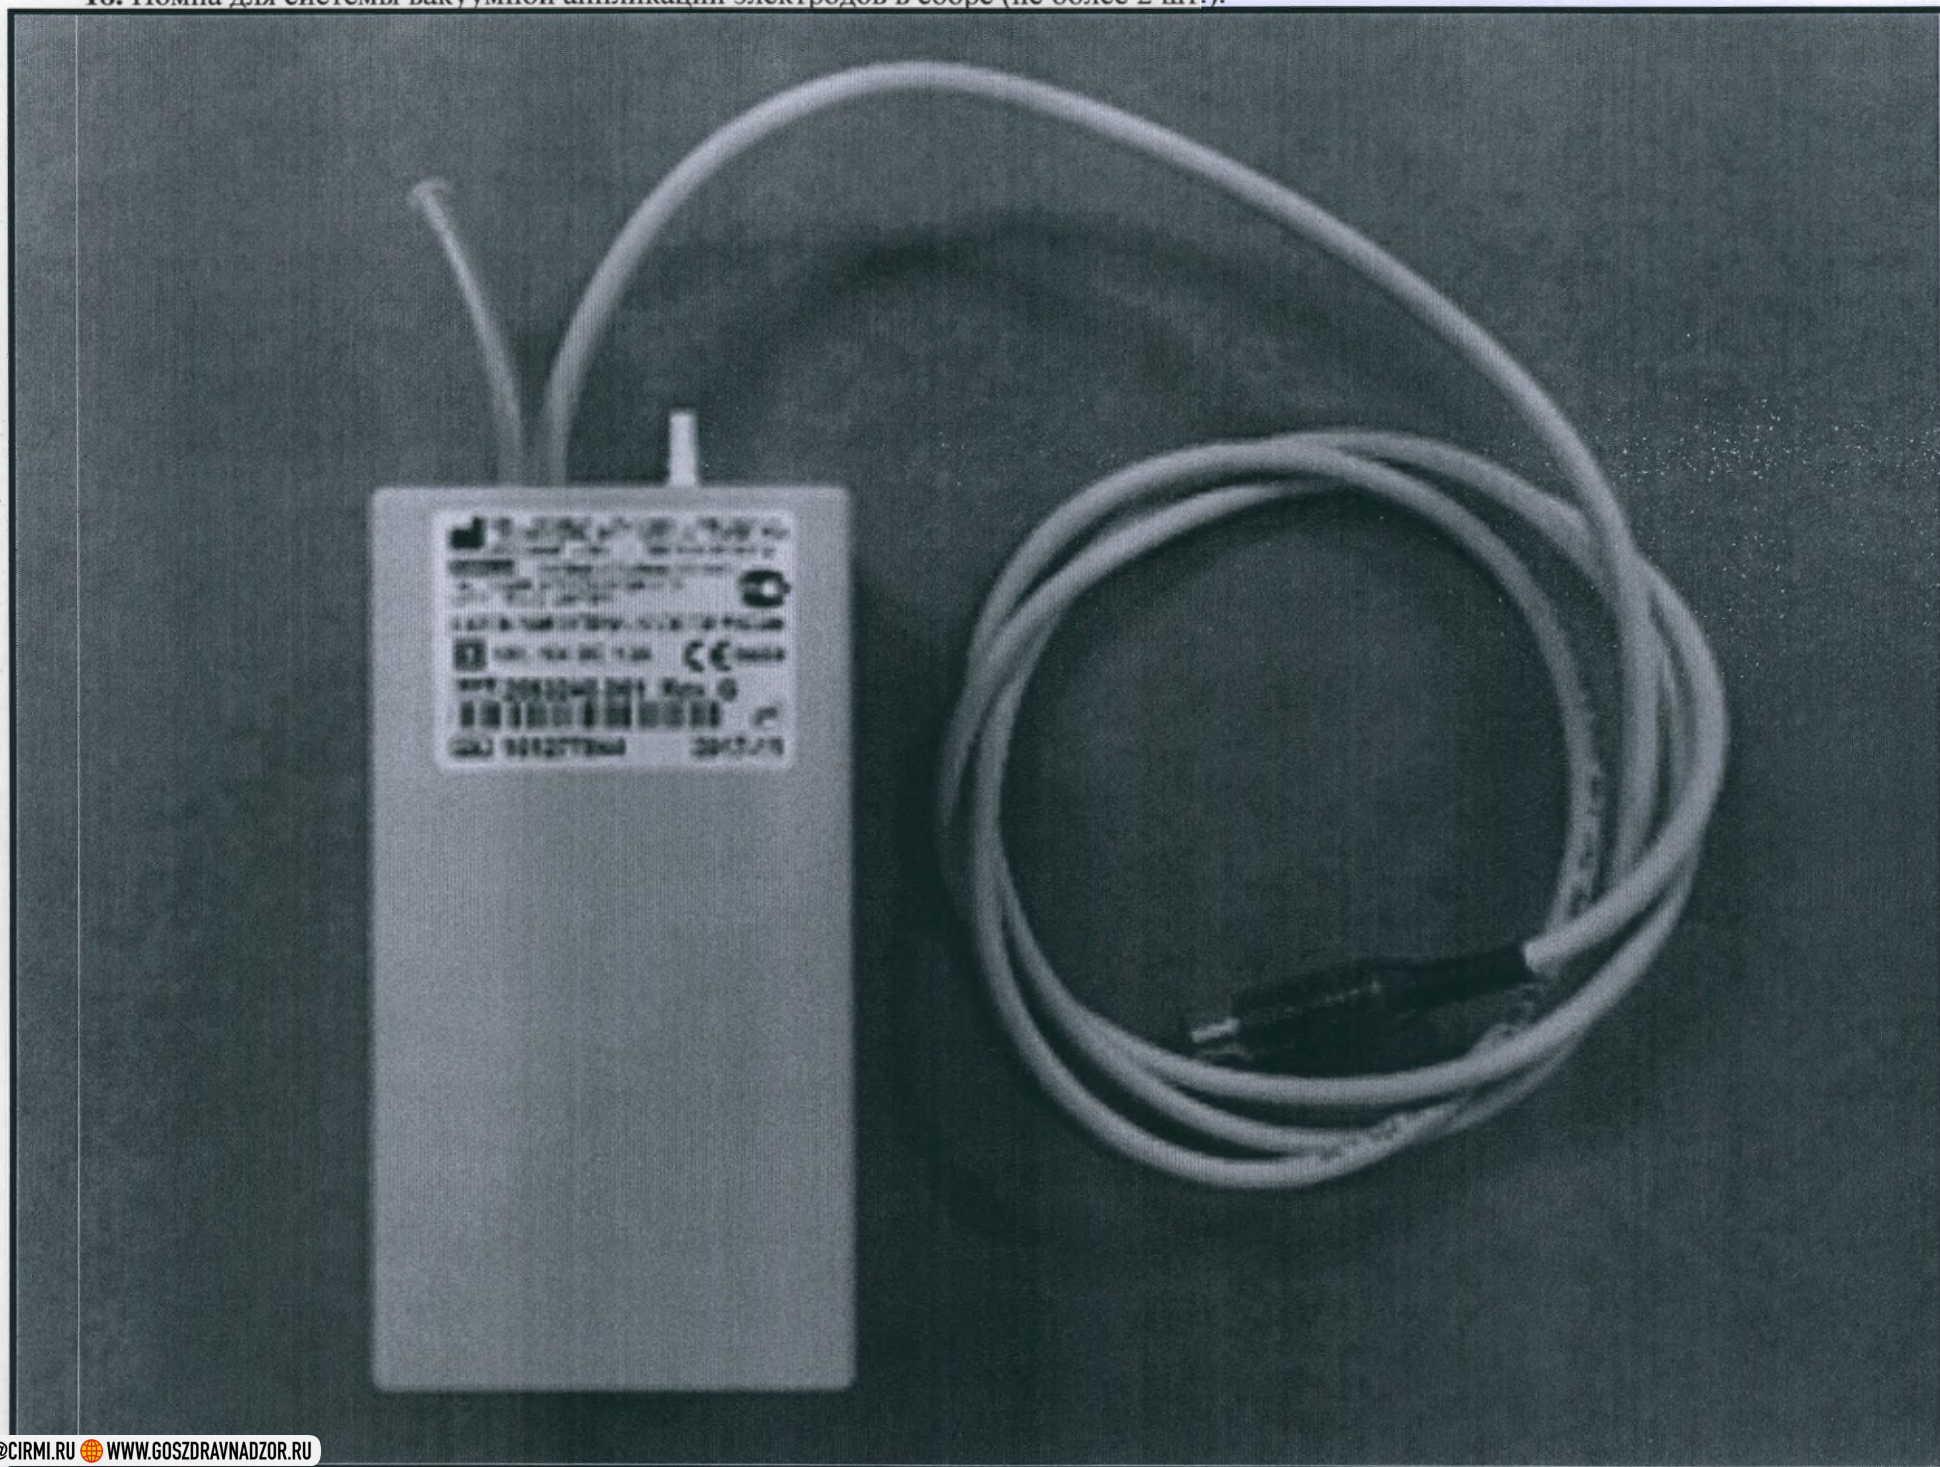


19. Крепление для помпы системы вакуумной аппликации электродов на тележке (не более 2 шт.).

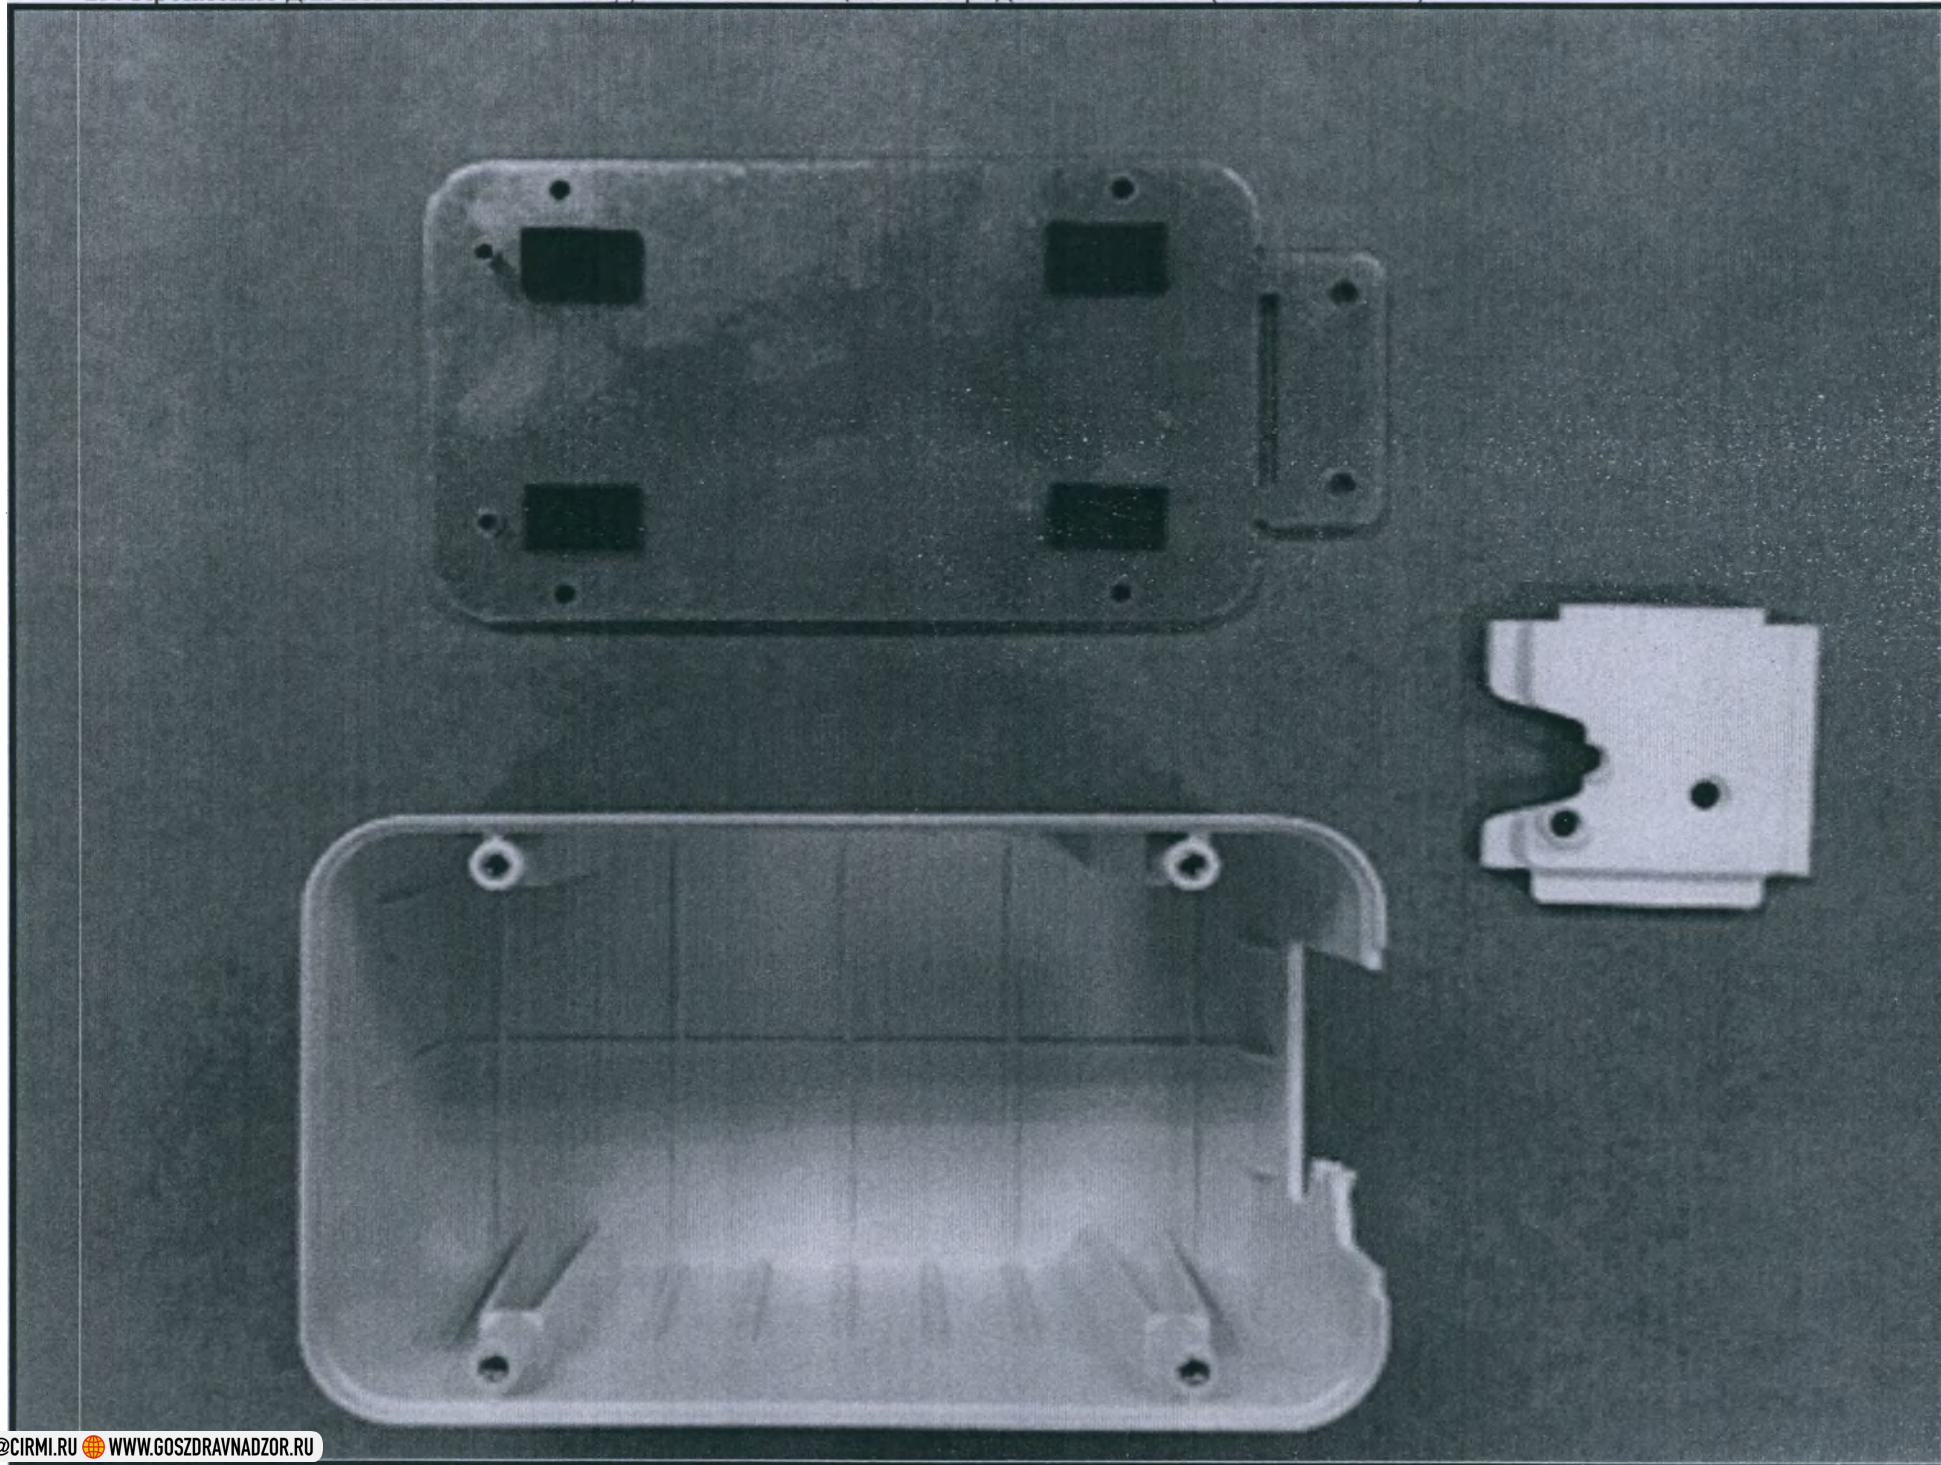


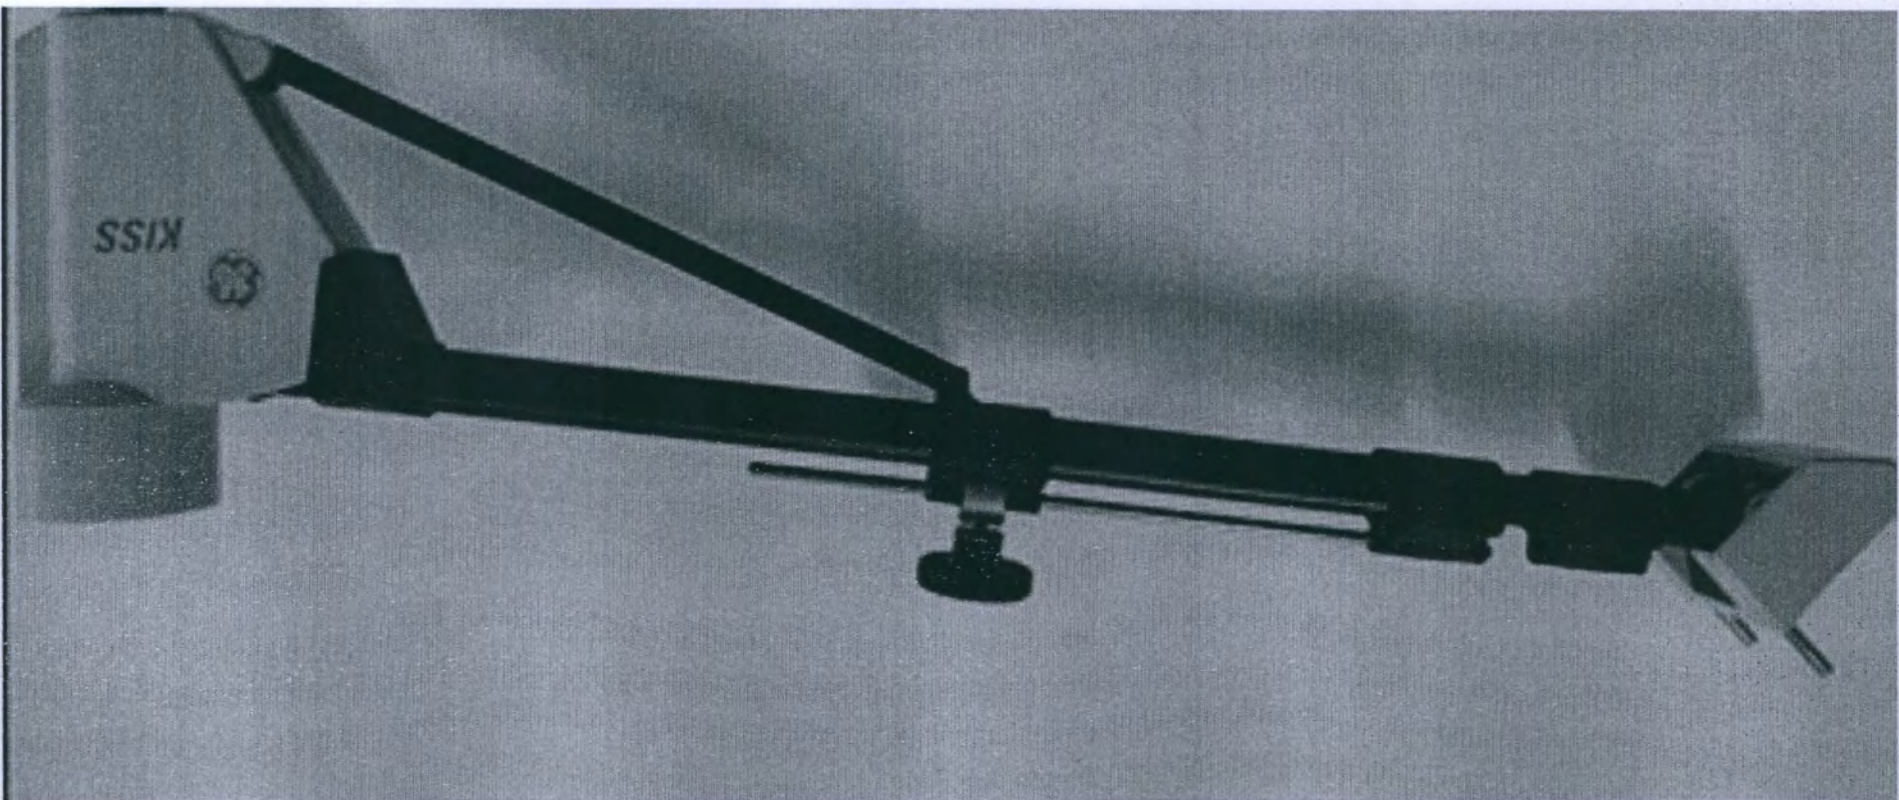

21. Крепление к столу для системы вакуумной аппликации электродов.

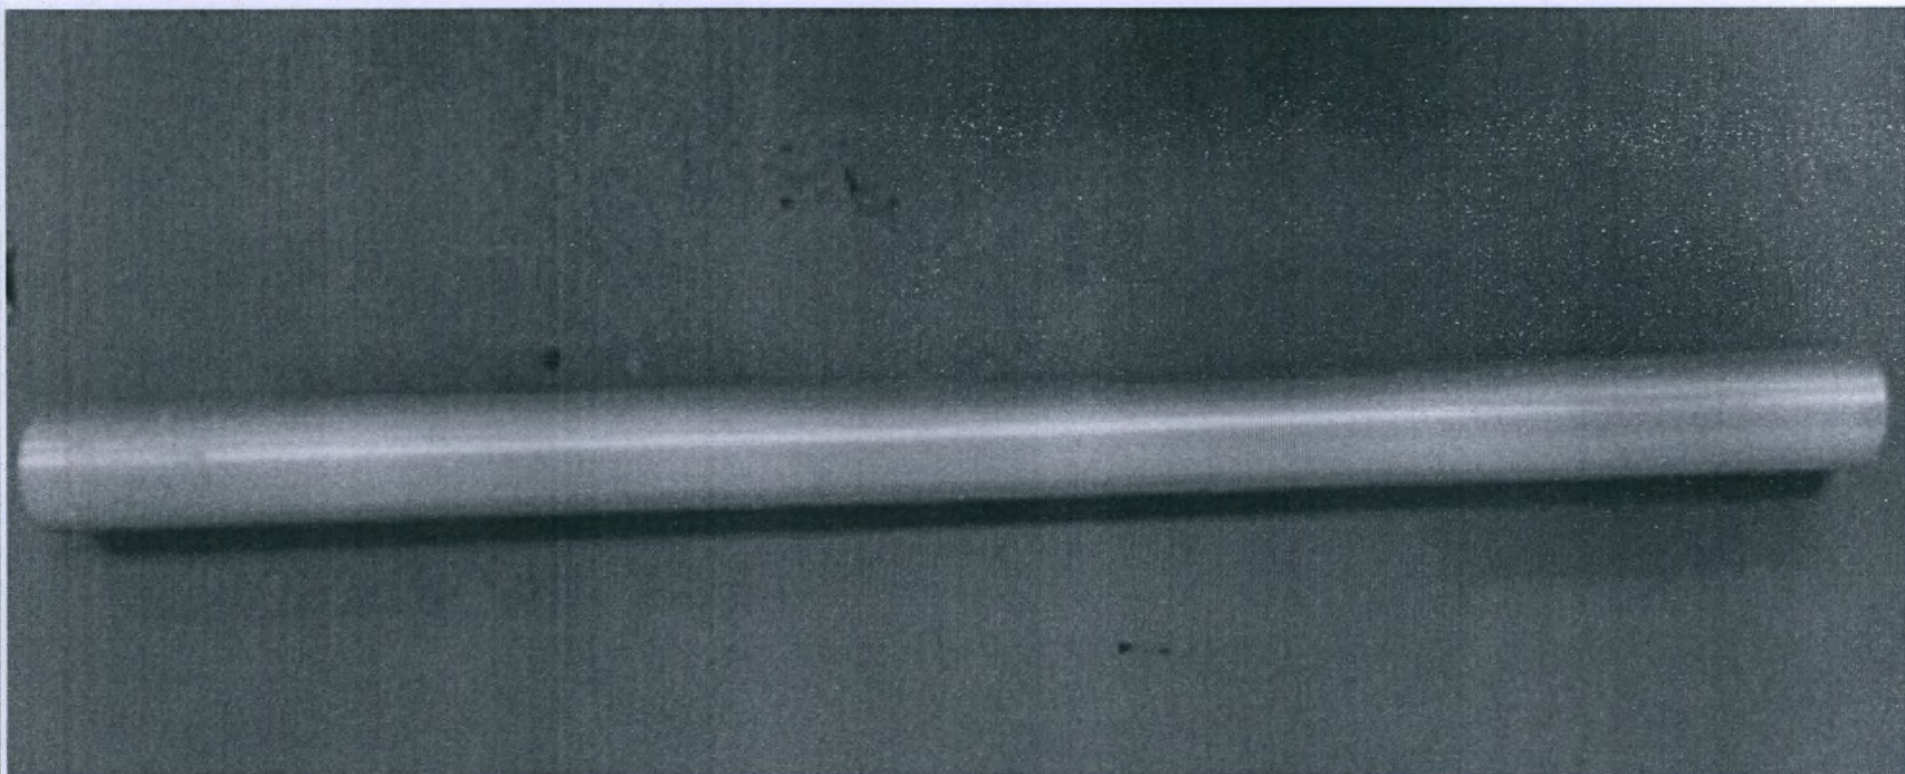


22. Крепление к стене для вакуумной аппликации электродов.

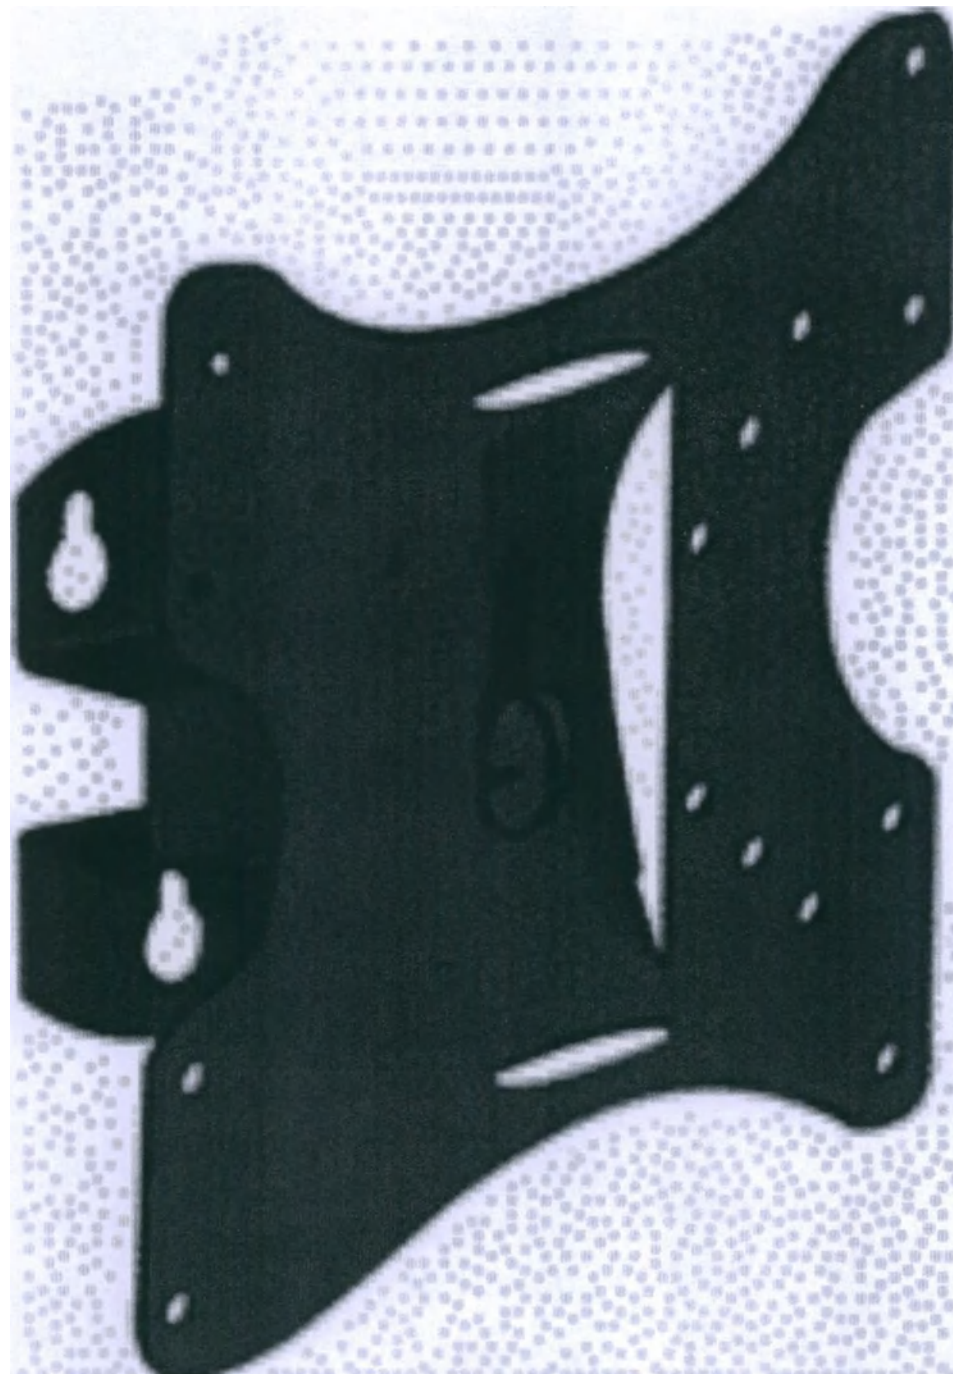


23. Устройство считывания штрих-кода.




24. Кабель USB для подключения принтера (не более 2шт.).

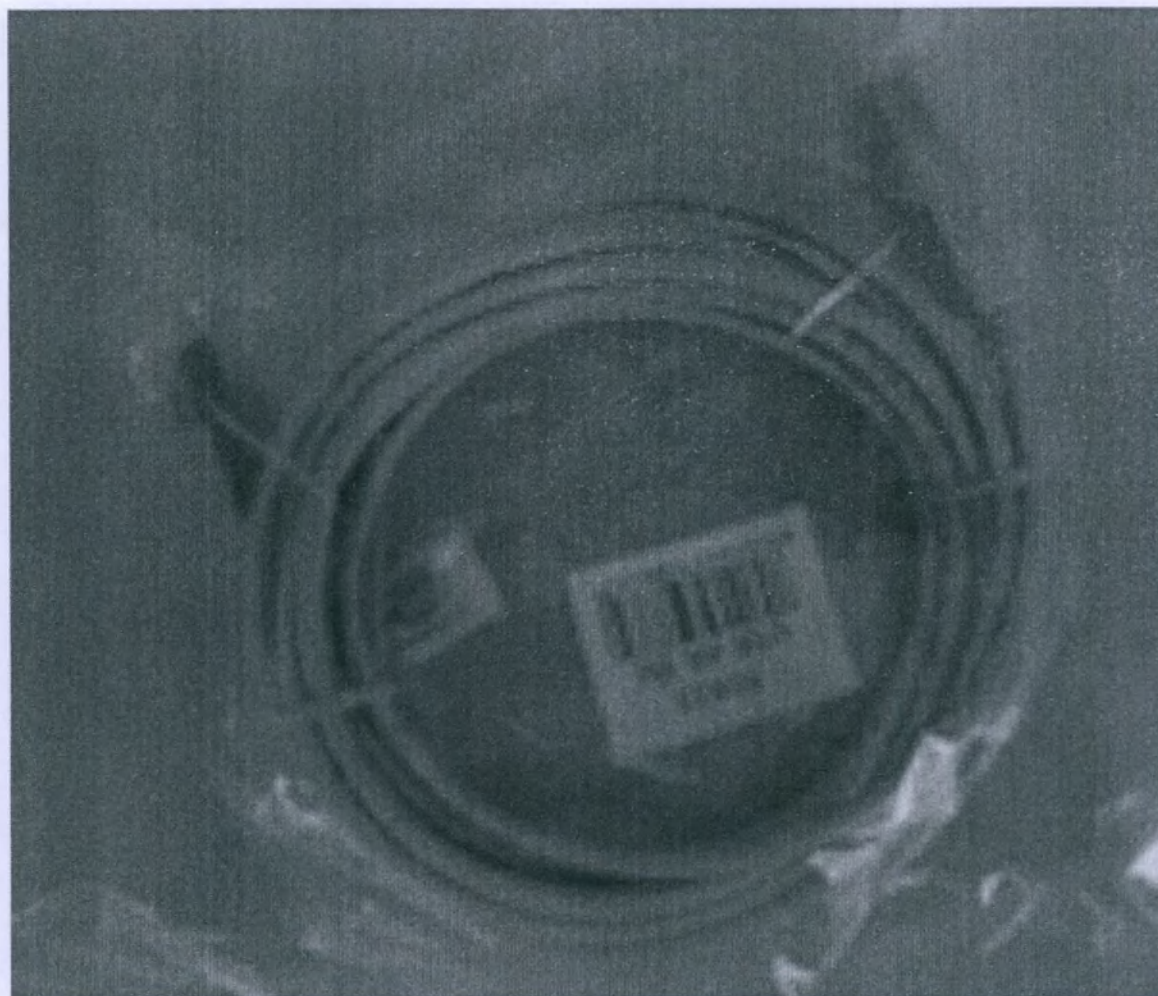

25. USB ключ цифровой (не более 2 шт.).

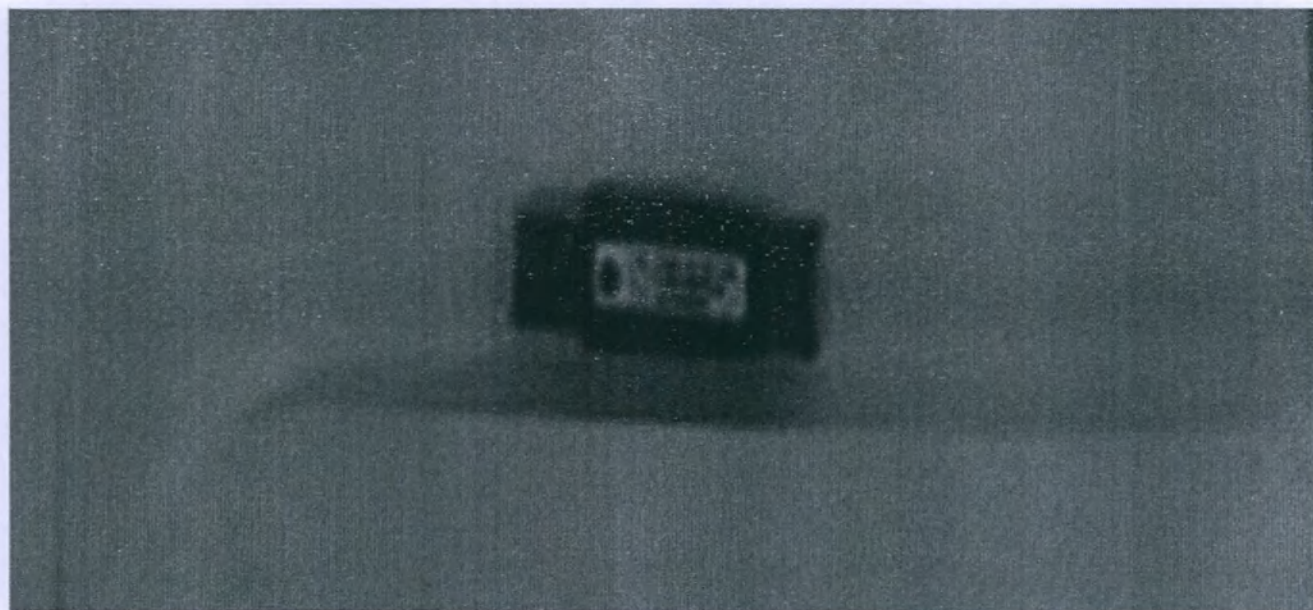



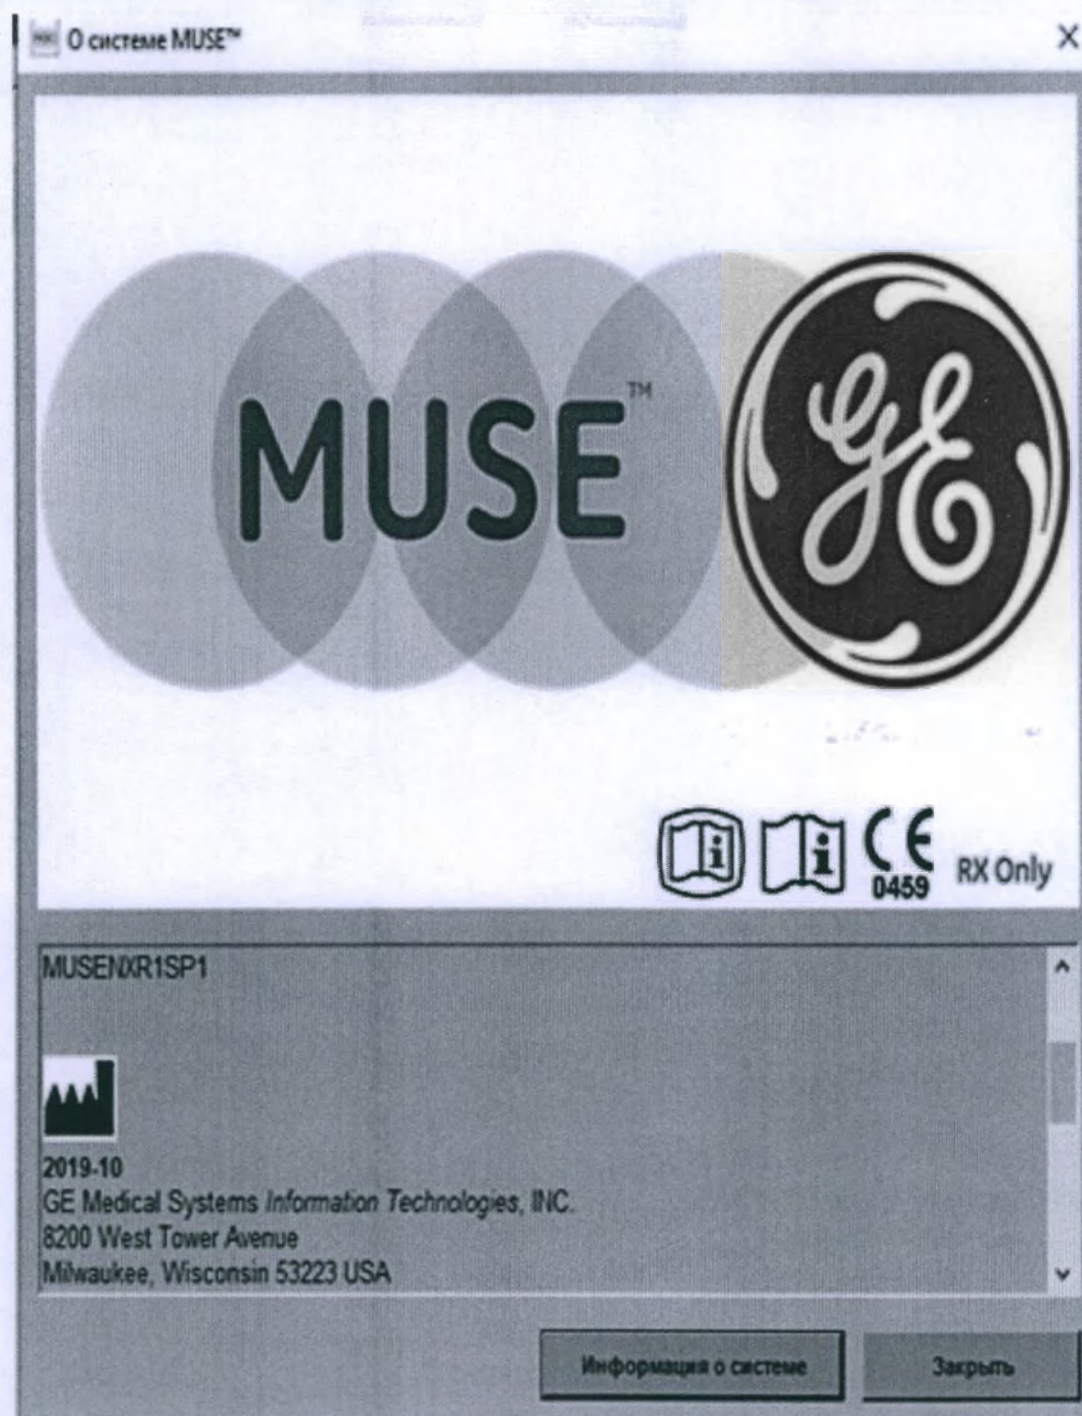

28. Программный ключ активации базового программного пакета на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе.

✖ Service

×

Device Information

Diagnostics

Audit Logs

Event Log

Transmission Log

Option Manager

Battery Metrics

Wireless

Software Upgrade

Format Internal Memory

Lead Fall Test

Export Logs

Performance Tool

Available Options

Enter the 12-digit code to enable the option

Save

Cancel

• BPCD - External Barcode Reader

• CRIT - Critical Value Notifications

• DIRM - Digital Rhythm

• AECC - Auto ECG

• M12 - 12SL Measurements and Interpretation

• XHLO - XHL Format Output

• ME12 - 12SL Measurements

• OROM - Order Manager

• ACCS - Acute Coronary Syndrome

Added Options

• FLOS - Full Disclosure

Remove

• WRLS - Global Wireless

29. Программный ключ активации клинического программного пакета на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе.

✖ Service

×

Device Information

Diagnostics

Audit Logs

Event Logs

Transmission Log

Option Manager

Battery Metrics

Wireless

Software Upgrade

Format Internal Memory

Lead Fall Test

Export Logs

Performance Tool

Available Options

Enter the 12-digit code to enable the option

Save

Cancel

• SPCD - External Barcode Reader

• CRIT - Critical Value Notifications

• DRHM - Digital Rhythm

• AECG - Auto ECG

• MI12 - 12SL Measurements and Interpretation

• XSLQ - XML Format Output

• ME12 - 12SL Measurements

• ORDH - Order Manager

• ACCS - Acute Coronary Syndrome

Added Options

• FLDG - Full Disclosure

Remove

• WRLS - Global Wireless

ООО ЦРПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

30. Программный ключ активации улучшенного клинического программного пакета на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе

 Service

Device Information

Diagnostics

Audit Log

Event Log

Transmission Log

Option Manager

Battery Metrics

Wireless

Software Upgrade

Format Internal Memory

Lead Fall Test

Export Logs

Performance Tool

Available Options

Enter the 12-digit code to enable the option

Save

Cancel

☒ BRCD - External Barcode Reader

☒ CRIT - Critical Value Notifications

☒ DRHM - Digital Rhythm

☒ AECG - Auto ECG

☒ ME12 - 12SL Measurements and Interpretation

☒ XMLC - XML Format Output

☒ ME12 - 12SL Measurements

☒ ORDH - Order Manager

☒ ACCS - Acute Coronary Syndrome

Added Options

☒ FLOS - Full Disclosure

Remove

☒ WRLS-Global Wireless

31. Программный ключ активации улучшенного программного пакета передачи данных на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе

✖ Service

✕

Device Information

Diagnostics

Audit Logs

Event Logs

Transmission Log

Option Manager

Battery Metrics

Wireless

Software Upgrade

Format Internal Memory

Lead Fall Test

Export Logs

Performance Tool

Available Options

Enter the 12-digit code to enable the option

Save

Cancel

• BRCD - External Barcode Reader

• CRIT - Critical Value Notifications

• DRHM - Digital Rhythm

• AECG - Auto ECG

• MI12 - 12SL Measurements and Interpretation

• XHLO - XHIL Format Output

• ME12 - 12SL Measurements

• ORDM - Order Manager

• ACCS - Acute Coronary Syndrome

Added Options

• ELOS - Full Disclosure

Remove

• WPLS-Global Wireless

32. Программный ключ активации передачи данных в кардиологическое программное обеспечение на оптических или электронных носителях или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.

Service

Device Information

Diagnostics

Audit Logs

Event Logs

Transmission Log

Option Manager

Battery Metrics

Wireless

Software Upgrade

Format Internal Memory

Lead Fall Test

Export Logs

Performance Tool

Available Options

Enter the 12-digit code to enable the option

Save

Cancel

• BRCD - External Barcode Reader

• DRHM - Digital Rhythm

• ME12 - 12SL Measurements and Interpretation

• ME12 - 12SL Measurements

• ACCS - Acute Coronary Syndrome

• CRIT - Critical Value Notifications

• AECG - Auto ECG

• XSLQ - XML Format Output

• ORDH - Order Manager

Added Options

• FLDS - Full Disclosure

Remove

• WRLS - Global Wireless

33. Программный ключ активации передачи данных для хранения данных через USB/LAN интерфейс на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе.

✖ Service

×

Device Information	Available Options Enter the 12-digit code to enable the option Save Cancel • BRCD - External Barcode Reader • CRT - Critical Value Notifications • DRHM - Digital Rhythm • AECC - Auto ECG • MI12 - 12SL Measurements and Interpretation • XMLO - XML Format Output • ME12 - 12SL Measurements • OROM - Order Manager • ACCS - Acute Coronary Syndrome	Added Options
Diagnostics		• FLOS - Full Disclosure Remove
Audit Logs		• WRLS - Global Wireless
Event Logs		
Transmission Log		
Order Manager		
Battery Metrics		
Wireless		
Software Upgrade		
Format Internal Memory		
Lead Fall Test		
Export Logs		
Performance Tool		

54. Программный ключ активации передачи данных для хранения на сервер F I P или общую папку на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе.

 Service

Device Information

Diagnostics

Audit Logs

Event Logs

Transmission Log

Option Manager

Battery Metrics

Wireless

Software Upgrade

Format Internal Memory

Lead Fall Test

Export Logs

Performance Tool

Available Options

Enter the 12-digit code to enable the option

Save

Cancel

☒ BRCD - External Barcode Reader

☒ CRIT - Critical Value Notifications

☒ DRHM - Digital Rhythm

☒ AECC - Auto ECG

☒ MI12 - 12SL Measurements and Interpretation

☒ XHLO - X2SL Format Output

☒ ME12 - 12SL Measurements

☒ ODOM - Order Manager

☒ ACCS - Acute Coronary Syndrome

Added Options

☒ FLOS - Full Disclosure

Remove

☒ WRLS-Global Wireless

35. Программный ключ активации хранения 1000 ЭКГ на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе.

✖ Service

×

Device Information

Diagnostics

Audit Logs

Event Logs

Transmission Log

Option Manager

Battery Metrics

Wireless

Software Upgrade

Format Internal Memory

Lead Fall Test

Export Logs

Performance Tool

Available Options

Enter the 12-digit code to enable the option

Save

Cancel

BCRD - External Barcode Reader

CRIT - Critical Value Notifications

DRHM - Digital Rhythm

AEOG - Auto ECG

MI12 - 12SL Measurements and Interpretation

X%LO - X%L Format Output

ME12 - 12SL Measurements

ORDM - Order Manager

ACCS - Acute Coronary Syndrome

Added Options

FLGS - Full Disclosure

Remove

WRLS-Global Wireless

ООО ЦРПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

36. Программный ключ активации алгоритма острого коронарного синдрома на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе.

✖ Service

×

Device Information

Diagnostics

Audit Logs

Event Logs

Transmission Log

Option Manager

Battery Metrics

Wireless

Software Upgrade

Format Internal Memory

Lead Fall Test

Export Logs

Performance Tool

Available Options

Enter the 12-digit code to enable the option

Save

Cancel

BRCD - External Barcode Reader

CRIT - Critical Value Notifications

DRHM - Digital Rhythm

AECG - Auto ECG

MI12 - 12SL Measurements and Interpretation

XMSLO - XML Format Output

ME12 - 12SL Measurements

ORDM - Order Manager

ACCS - Acute Coronary Syndrome

Added Options

FLDS - Full Challenge

Remove

WRLS - Global Wireless

ООО ЦРПМ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

37. Программный ключ активации программного обеспечения критических значений на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе.

✖ Service

×

Device Information	Available Options Enter the 12-digit code to enable the option SaveCancel ⚙ BRCD - External Barcode Reader ⚙ CRIT - Critical Value Notifications ⚙ DRHM - Digital Rhythm ⚙ AECG - Auto ECG ⚙ HI12 - 12SL Measurements and Interpretation ⚙ XHLO - XHL Format Output ⚙ HE12 - 12SL Measurements ⚙ ORDM - Order Manager ⚙ ACCS - Acute Coronary Syndrome	Added Options
Diagnostics		
Audit Logs		
Event Logs		
Transmission Log		
Option Manager		
Battery Metrics		
Wireless		
Software Upgrade		
Format Internal Memory		
Lead Fall Test		
Export Logs		
Performance Tool		

⚙ FLDS - Full Disclosure

Remove

⚙ WRLS - Global Wireless

38. Программный ключ активации автоматического старта записи ЭКГ на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе.

✖ Service

×

Device Information	Available Options	Added Options
Diagnostics		
Audit Logs		
Event Logs		
Transmission Log		
Option Manager		
Battery Metrics		
Wireless		
Software Upgrade		
Format Internal Memory		
Lead Fall Test		
Export Logs		
Performance Tool		

Enter the 12-digit code to enable the option

Save

Cancel

• BRCD - External Barcode Reader

• CRIT - Critical Value Notifications

• DRHM - Digital Rhythm

• AECG - Auto ECG

• HI12 - 12SL Measurements and Interpretation

• XSLD - XML Format Output

• HE12 - 12SL Measurements

• ORDH - Order Manager

• ACCS - Acute Coronary Syndrome

• FLOS - Full Disclosure

Remove

• WRLS - Global Wireless

39. Программный ключ активации полной записи 'ЭКГ' на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе.

✖ Service

×

Device Information

Diagnostics

Audit Logs

Event Logs

Transmission Log

Option Manager

Battery Metrics

Wireless

Software Upgrade

Format Internal Memory

Lead Fall Test

Export Logs

Performance Tool

Available Options

Enter the 12-digit code to enable the option

SaveCancel

BRCD - External Barcode Reader

DRHM - Digital Rhythm

MI12 - 12SL Measurements and Interpretation

ME12 - 12SL Measurements

ACCS - Acute Coronary Syndrome

CRIT - Critical Value Notifications

AECG - Auto ECG

XMLE - XML Format Output

ORDM - Order Manager

Added Options


FLOS - Full Disclosure

Remove

WRLS-Global Wireless

ООО ЦРПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

40. Программный ключ активации хранения ритма в цифровом формате на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе.

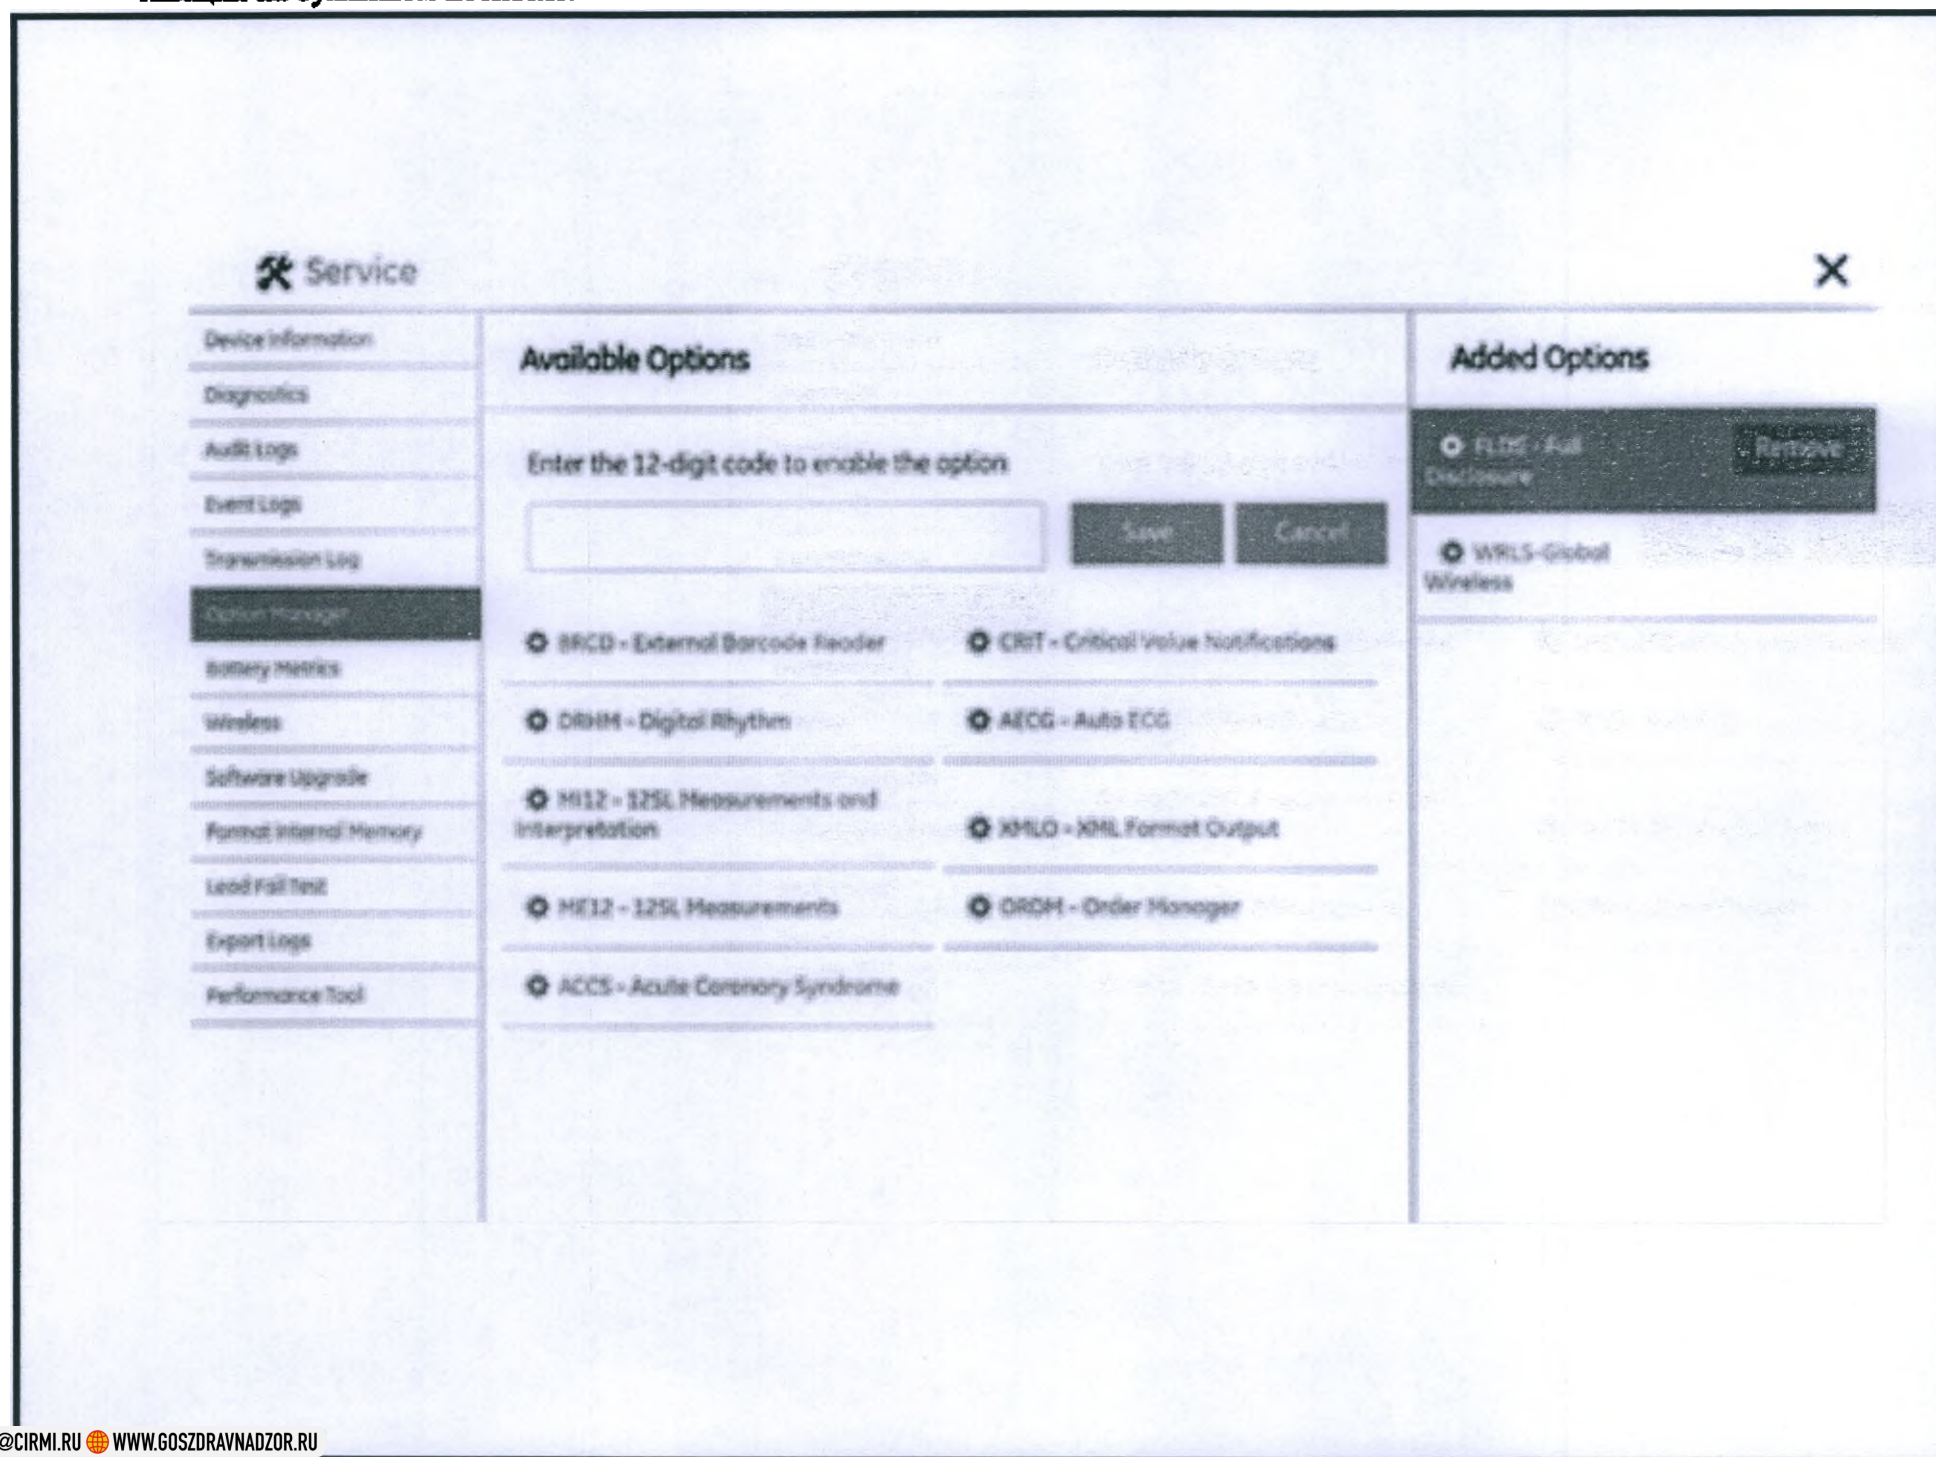

41. Программный ключ активации двустороннего обмена данными с кардиологическим программным обеспечением с электронной медицинской картой на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе.

 Service

Device Information

Diagnostics

Audit Logs

Event Logs

Transmission Log

Order Manager

Battery Metrics

Wireless

Software Upgrade

Format Internal Memory

Lead Fall Test

Export Logs

Performance Tool

Available Options

Enter the 12-digit code to enable the option

SaveCancel

☐ BRCD - External Barcode Reader

☐ CRIT - Critical Value Notifications

☐ DRHM - Digital Rhythm

☐ AECG - Auto ECG

☐ HI12 - 12SL Measurements and Interpretation

☐ XHLO - XHL Format Output

☐ ME12 - 12SL Measurements

☐ ORDM - Order Manager

☐ ACCS - Acute Coronary Syndrome

Added Options

☒ FLD5 - Full Disclosure

Remove

☒ WRLS - Global Wireless

42. Программный пакет для активации программного обеспечения интерфейс EMR Gateway Pro на оптических или электронных носителях, или код активации на бумажном носителе.

✖ Service

×

Device Information

Diagnostics

Audit Logs

Event Logs

Transmission Log

Option Manager

Battery Metrics

Wireless

Software Upgrade

Format Internal Memory

Lead Fall Test

Export Logs

Performance Tool

Available Options

Enter the 12-digit code to enable the option

Save

Cancel

• BRCD - External Barcode Reader

• CRIT - Critical Value Notifications

• DRRH - Digital Rhythm

• AECG - Auto ECG

• ME12 - 12SL Measurements and Interpretation

• XHLO - XML Format Output

• ME12 - 12SL Measurements

• ORDM - Order Manager

• ACCS - Acute Coronary Syndrome

Added Options

• FLOS - Full Disclosure

Remove

• WRLS-Global Wireless

43. Программный ключ активации передачи данных по беспроводному интерфейсу для хранения данных на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе.

✖ Service

×

Device Information

Diagnostics

Audit Logs

Event Logs

Transmission Log

Option Manager

Battery Metrics

Wireless

Software Upgrade

Format Internal Memory

Lead Fall Test

Export Logs

Performance Tool

Available Options

Enter the 12-digit code to enable the option

Save

Cancel

• BRCD - External Barcode Reader

• CRIT - Critical Value Notifications

• DRHM - Digital Rhythm

• AECC - Auto ECG

• M112 - 12SL Measurements and Interpretation

• XMLO - XML Format Output

• ME12 - 12SL Measurements

• ORDH - Order Manager

• ACCS - Acute Coronary Syndrome

Added Options

• FLDs - Full Disclosure

Remove

• WRLS-Global Wireless

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

44. Программный ключ активации считывания штрих-кодов на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе.

 Service

Device Information

Diagnostics

Audit Logs

Event Logs

Transmission Log

Option Manager

Battery Metrics

Wireless

Software Upgrade

Format Internal Memory

Lead Fall Test

Export Logs

Performance Tool

Available Options

Enter the 12-digit code to enable the option

Save

Cancel

☐ BPCD - External Barcode Reader

☐ CRIT - Critical Value Notifications

☐ DBHM - Digital Rhythm

☐ AECG - Auto ECG

☐ MI12 - 12SL Measurements and Interpretation

☐ X2SLQ - X2SL Format Output

☐ ME12 - 12SL Measurements

☐ ORDH - Order Manager


☐ ACCS - Acute Coronary Syndrome

Added Options

☒ FLOK - Full Disclosure

Remove

☒ WRLS-Global Wireless

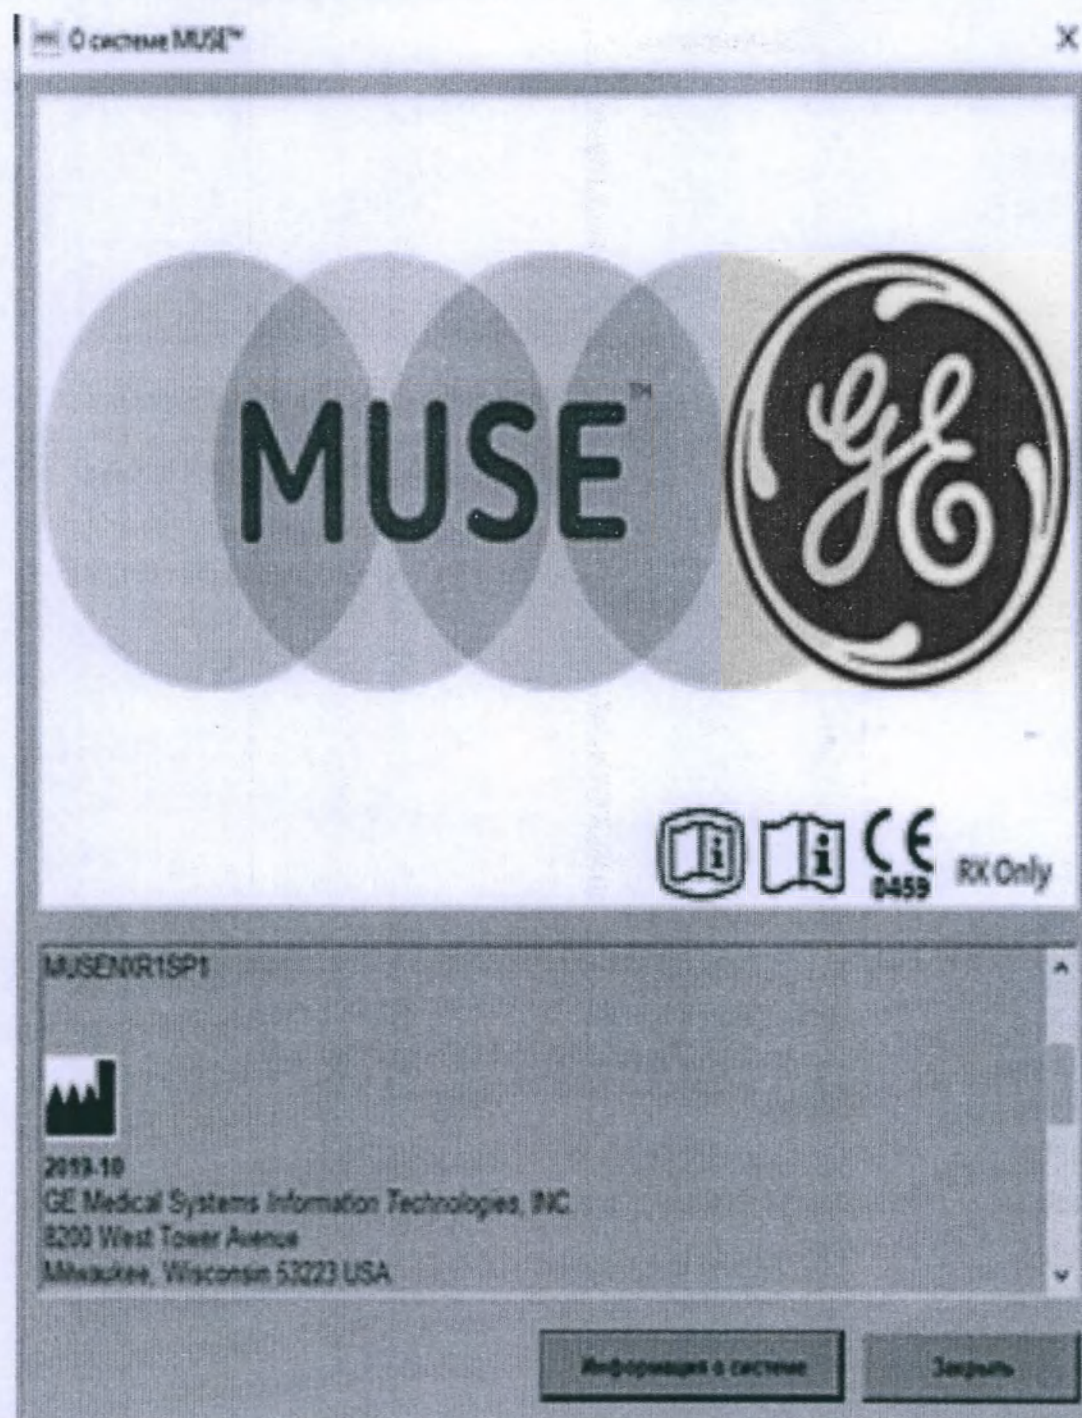

46. Программный ключ активации клинического программного пакета на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.

✖ Service

Device Information

Diagnostics

Audit Logs

Event Log

Transmission Log

Option Manager

Battery Metrics

Wireless

Software Upgrade

Formatted Internal Memory

Lead Fall Test

Export Logs

Performance Tool

Available Options

Enter the 12-digit code to enable the option

Save

Cancel

BRCD - External Barcode Reader

CRIT - Critical Value Notifications

DRHM - Digital Rhythm

AECG - Auto ECG

HE12 - 12SL Measurements and Interpretation

XPLO - XPL Format Output

HE12 - 12SL Measurements

ORDM - Order Manager

ACCS - Acute Coronary Syndrome

Added Options

FLDC - Full Disclosure

Remove

WRLS-Global Wireless

47. Программный ключ активации улучшенного клинического программного пакета на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе для установки обновлений

✖ Service

×

Device Information	Available Options Enter the 12-digit code to enable the option SaveCancel ⊙ SKCD - External Barcode Reader ⊙ CRIT - Critical Value Notifications ⊙ DRHM - Digital Rhythm ⊙ AECG - Auto ECG ⊙ MI12 - 12SL Measurements and Interpretation ⊙ XSLQ - XML Format Output ⊙ ME12 - 12SL Measurements ⊙ OROH - Order Manager ⊙ ACCS - Acute Coronary Syndrome	Added Options ⊙ FLOS - Full Disclosure Remove ⊙ WRLS-Global Wireless
Diagnostics		
Audit Logs		
Event Logs		
Transmission Log		
Option Manager		
Battery Metrics		
Wireless		
Software Upgrade		
Format Internal Memory		
Lead Fall Test		
Export Logs		
Performance Tool		

48. Программный ключ активации улучшенного программного пакета передачи данных на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе для установки обновлений

✖ Service

×

Device Information

Diagnostics

Audit Logs

Event Logs

Transmission Log

Option Manager

Battery Metrics

Wireless

Software Upgrade

Format Internal Memory

Lead Pile Test

Export Logs

Performance Tool

Available Options

Enter the 12-digit code to enable the option

Save

Cancel

BRCD - External Barcode Reader

CRIT - Critical Value Notifications

DRHM - Digital Rhythm

AECG - Auto ECG

M12 - 12SL Measurements and Interpretation

XHLQ - XHL Format Output

MEL2 - 12SL Measurements

ORDM - Order Manager

ACCS - Acute Coronary Syndrome

Added Options

FLDS - Full Disclosure

Remove

WRLS-Global Wireless

ООО ЦРПМ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

49. Программный ключ активации передачи данных по беспроводному интерфейсу для хранения данных на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.

 Service

Device Information

Diagnostics

Audit Logs

Event Logs

Transmission Log

Option Manager

Battery Metrics

Wireless

Software Upgrade

Format Internal Memory

Lead Fall Test

Export Logs

Performance Tool

Available Options

Enter the 12-digit code to enable the option

Save

Cancel

 BRCD - External Barcode Reader

 CRIT - Critical Value Notifications

 DRHM - Digital Rhythm

 AECG - Auto ECG

 MI12 - 12SL Measurements and Interpretation

 XMLO - XML Format Output

 ME12 - 12SL Measurements

 ORDH - Order Manager

 ACCS - Acute Coronary Syndrome

Added Options

 FLTS - Full Disclosure

Remove

 WPLS - Global Wireless

50. Программный ключ активации считывания штрих-кодов на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.

✖ Service

✕

Device Information

Diagnostics

Audit Logs

Event Logs

Transmission Log

Option Manager

Battery Metrics

Wireless

Software Upgrade

Format Internal Memory

Lead Fall Test

Export Logs

Performance Tool

Available Options

Enter the 12-digit code to enable the option

Save

Cancel

BCD - External Barcode Reader

CRIT - Critical Value Notifications

DtRM - Digital Rhythm

AECG - Auto ECG

MI12 - 12SL Measurements and Interpretation

XPL0 - XPL Format Output

HE12 - 12SL Measurements

ORDM - Order Manager

ACCS - Acute Coronary Syndrome

Added Options

FLDS - Full Disclosure

Remove

WRLS - Global Wireless

ООО ЦРПМ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


51. Программное обеспечение на оптических или электронных носителях и/или код активации на бумажном носителе для установки обновлений.

✖ Service

×

Device Information	Available Options Enter the 12-digit code to enable the option SaveCancel • BRCD - External Barcode Reader • CRIT - Critical Value Notifications • DRHM - Digital Rhythm • ACCG - Auto ECG • MI12 - 12SL Measurements and Interpretation • XHLO - XHL Format Output • ME12 - 12SL Measurements • OROM - Order Manager • ACCS - Acute Coronary Syndrome	Added Options • FLOS - Full Disclosure Remove • WRLS-Global Wireless
Diagnostics		
Audit Logs		
Event Logs		
Transmission Log		
Option Manager		
Battery Metrics		
Wireless		
Software Upgrade		
Format Internal Memory		
Lead Fall Test		
Export Logs		
Performance Tool		

52. Терморегистратор, производитель GE Medical Systems Information Technologies, Inc., США.

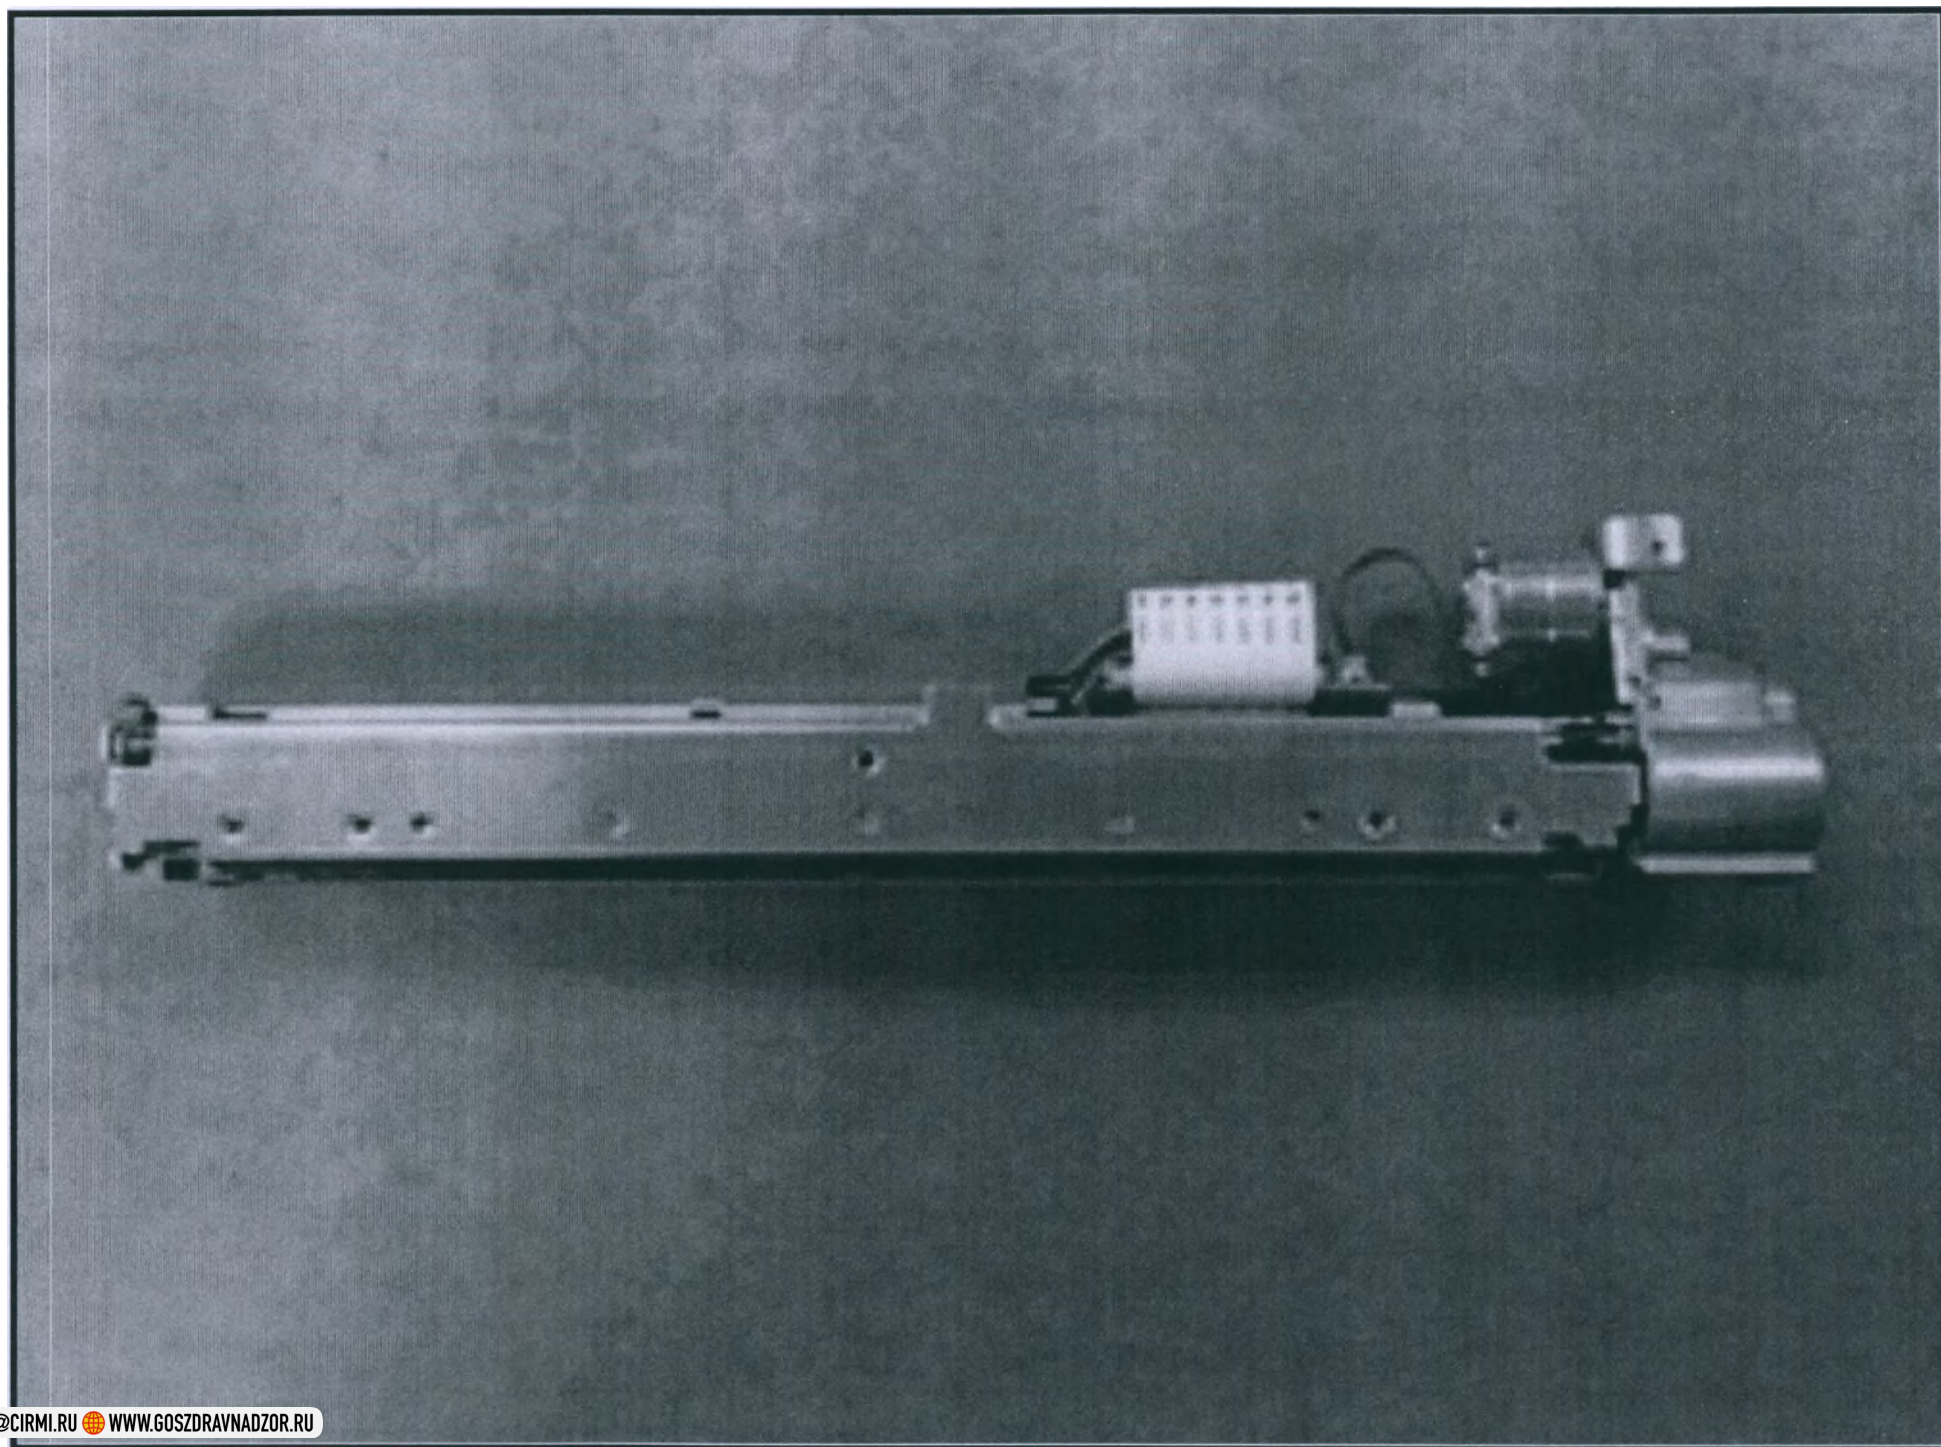

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____

150 _____ листах

А.И.Иванова

