

УТВЕРЖДАЮ

Общество с ограниченной ответственностью



«ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ»

Генеральный директор

Татаринов А.М.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ «ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ ELASTY С ГИАЛУРОНАТОМ НАТРИЯ 24 МГ/МЛ С ЛИДОКАИНОМ 3 МГ/МЛ, В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ»

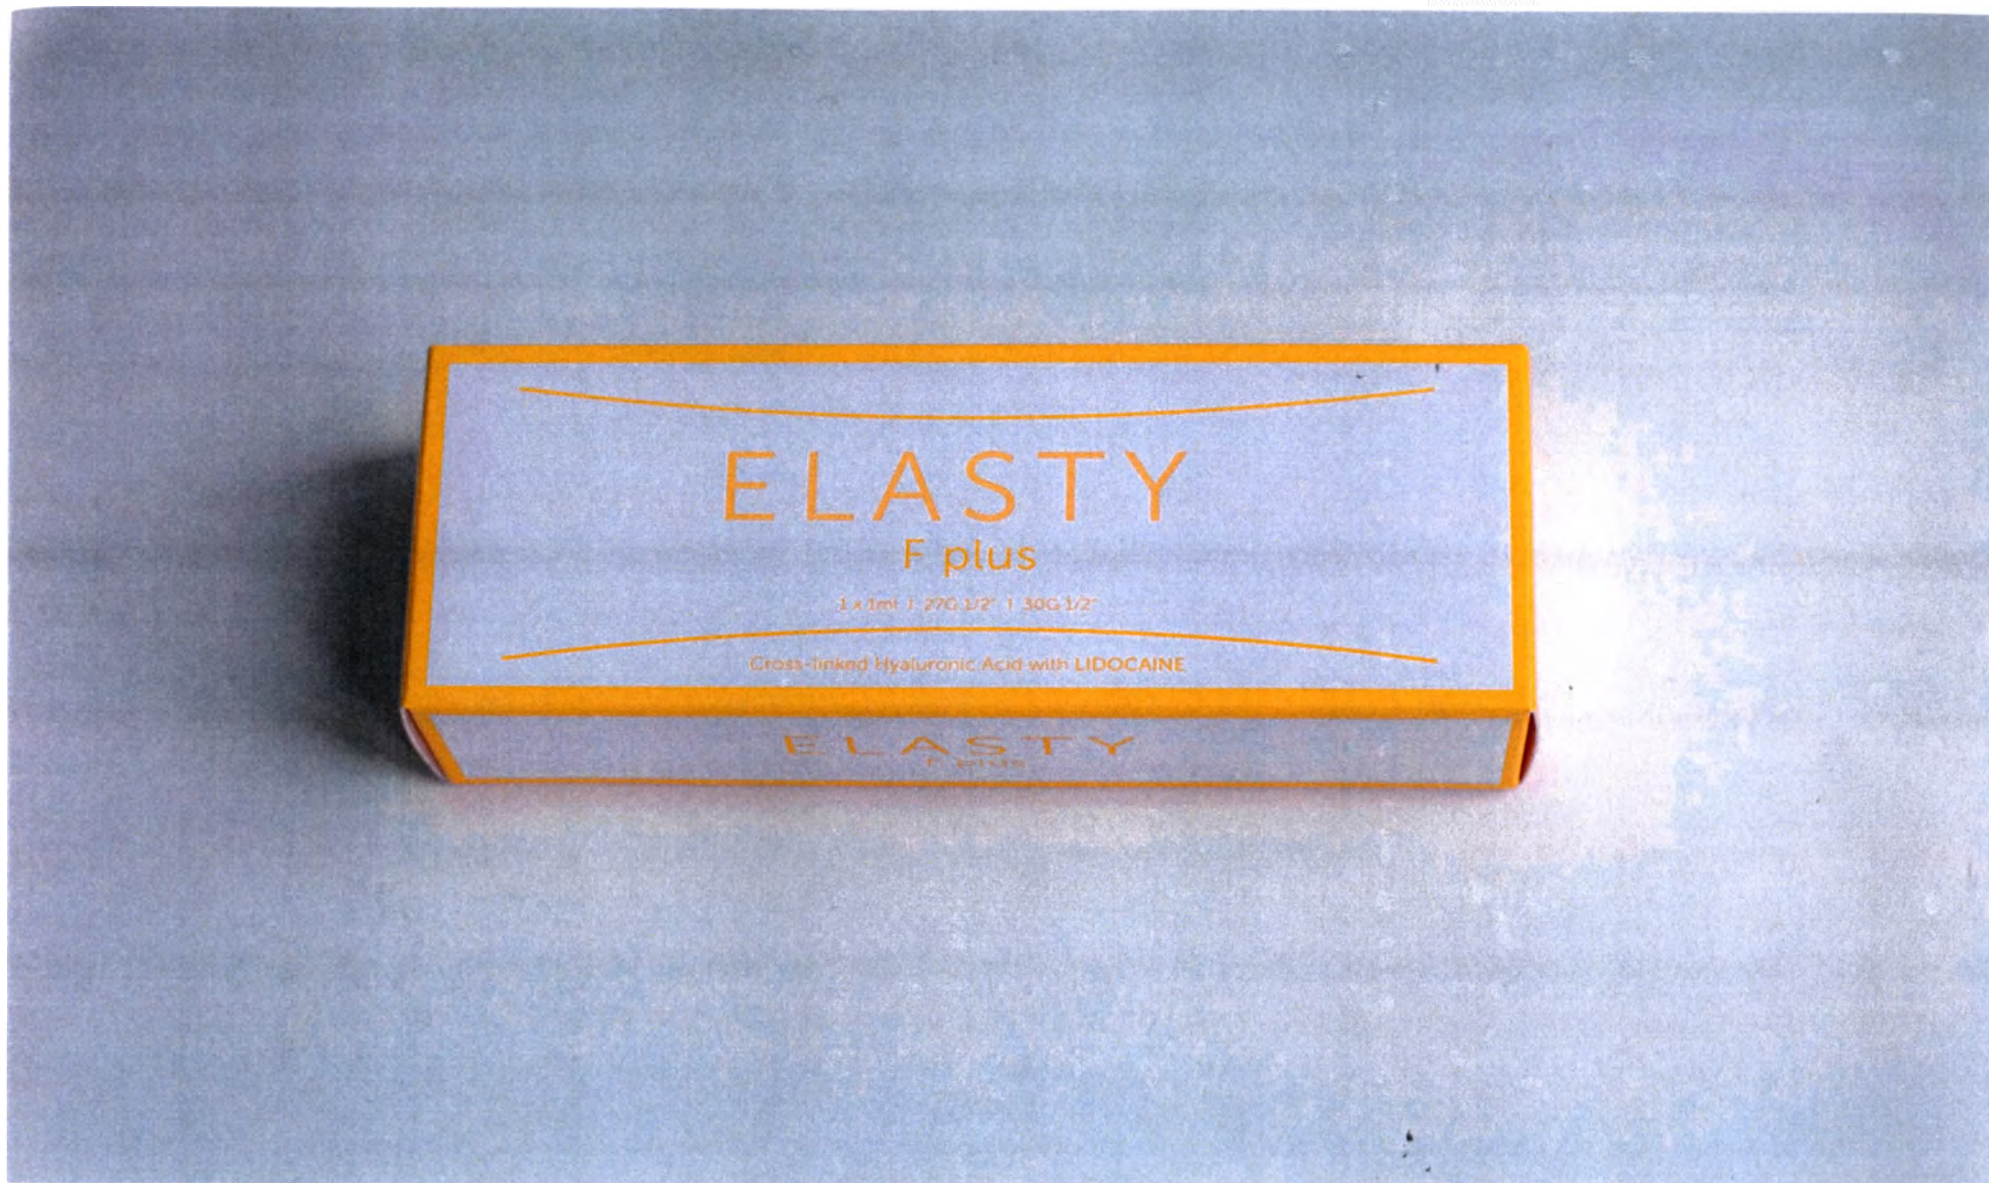


Рис. 1. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны картонной коробки ELASTY F plus.

Имплантат внутридермальный с гиалуронатом натрия 24 мг/мл и лидокаином 3 мг/мл «ELASTY», в вариантах исполнения
Имплантат внутридермальный с гиалуронатом натрия 24 мг/мл и лидокаином 3 мг/мл «Elasty F Plus».

в составе:

1. Стекланный шприц наполненный, производства POONGLIM Pharmatech Inc., Республика Корея, объем тела 1,0 мл – 2 шт.;
2. Игла инъекционная однократного применения 27Gx1/2" (0.4x13 мм), производства «Фил Тэк Ко., Лтд», Республика Корея, РУ №ФСЗ 2012/13433 - 2 шт.;
3. Игла инъекционная однократного применения 30Gx1/2" (0.3x13 мм), производства «Фил Тэк Ко., Лтд», Республика Корея, РУ №ФСЗ 2012/13433 - 2 шт.;
4. Инструкция по применению – 1 шт.;
5. Самоклеящаяся этикетка - 4 шт.

Медицинское изделие предназначено для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве временного заполнителя для увеличения объема мягких лицевых тканей, коррекции несовершенств кожи.

ELASTY G plus применяется для коррекции носа, подбородка, лба, шрамов и глубоких морщин. Инъекции проводятся в глубокие слои дермы. Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия применения: см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерильно. Не токсично. Срок годности: 2 года. Дата производства и срок годности указаны на упаковке и блистере. Годен до – см на упаковке.

Условия хранения: Хранить при температуре от 2 °C до 25 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель: Dong Bang Medical Co., Ltd., BDTP A#105, #606-2, #103 697 Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия: ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ» 107564, Москва, ул. 1-ая Мясниковская д. 2, кв.5, Тел.: +7 495 414 43 00, E-mail: info@developconsult.ru. Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.

STERILE



MADE IN KOREA

Рис. 2. На фотографии приведен общий вид оборотной стороны картонной коробки ELASTY F plus.

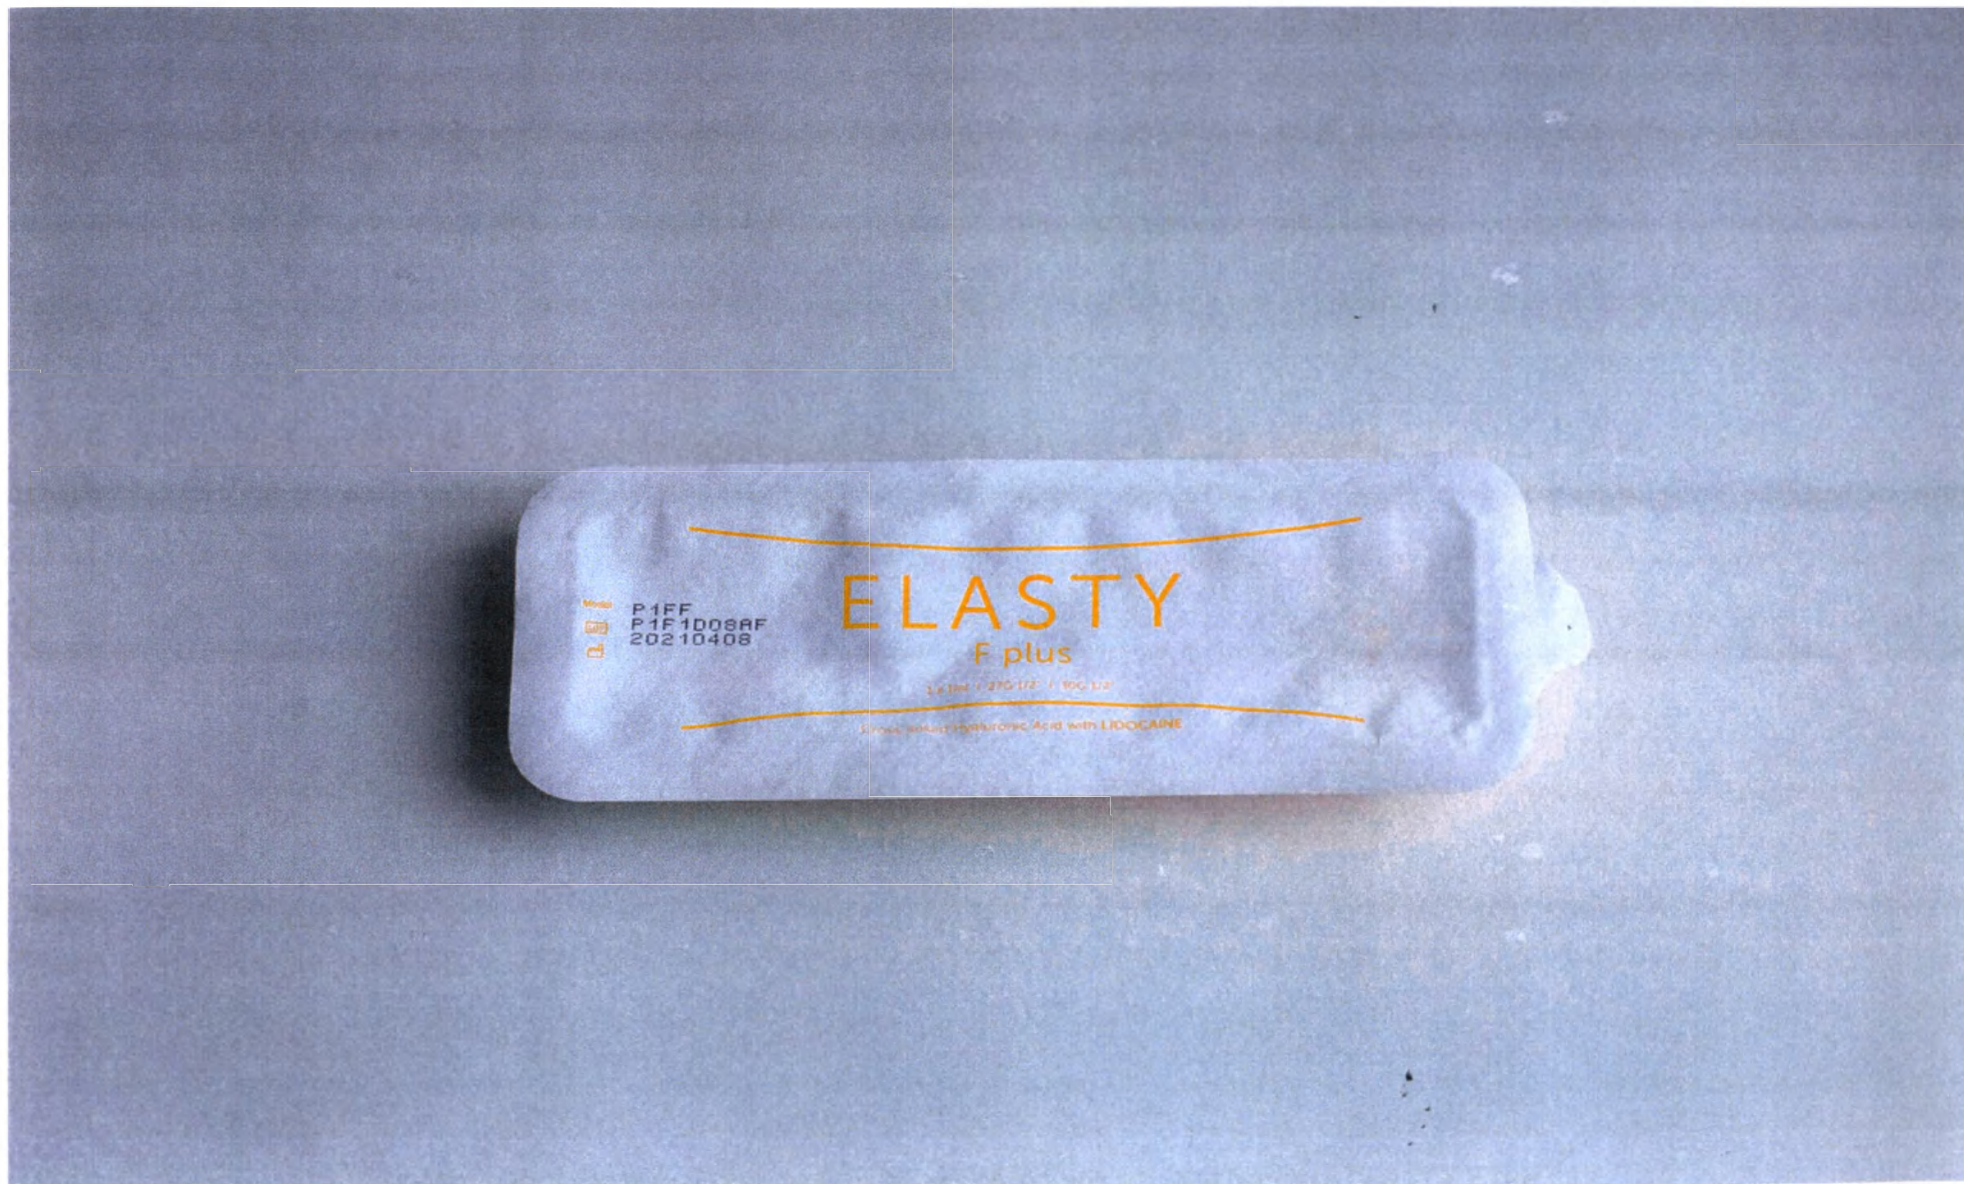


Рис. 3. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны блистера ELASTY F plus.

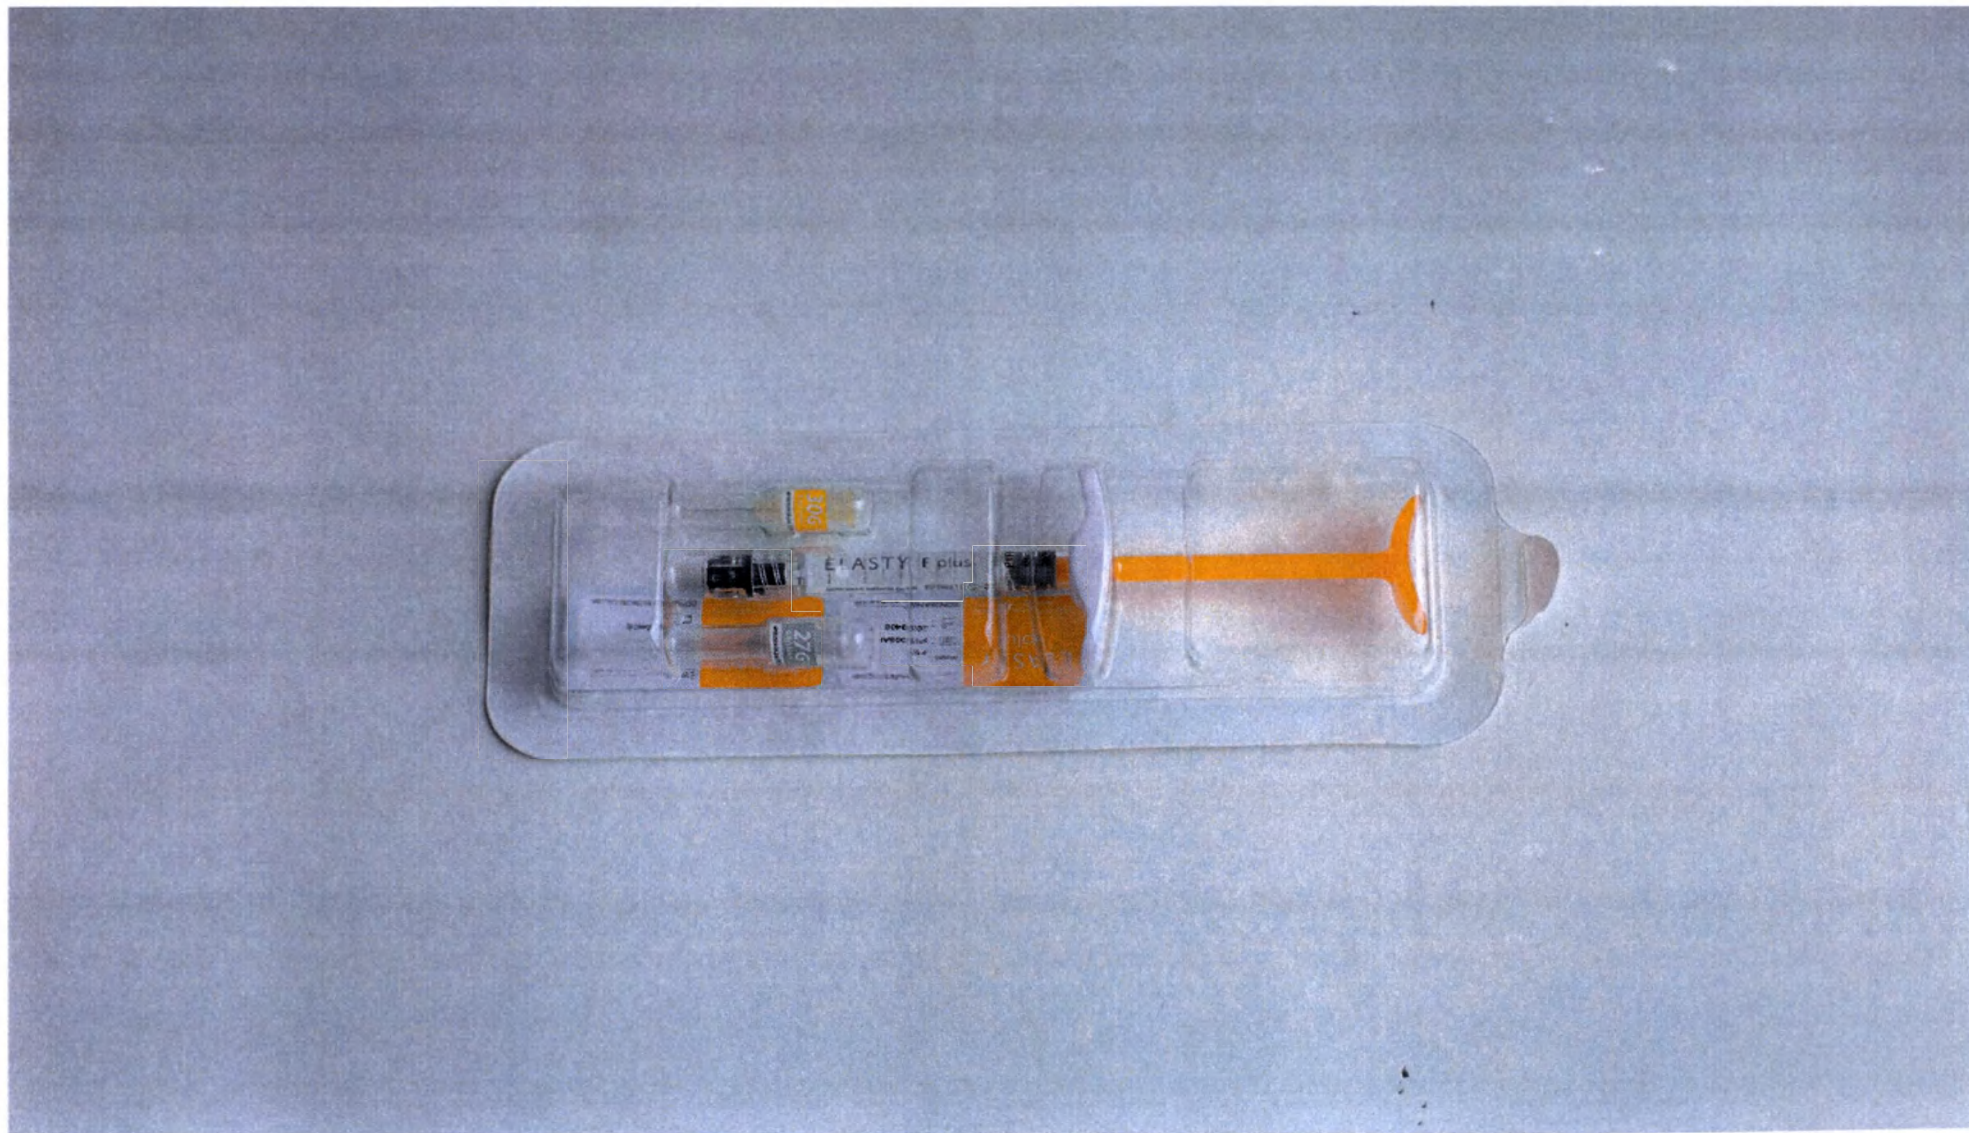


Рис. 4. На фотографии приведен общий вид оборотной стороны блистера ELASTY F plus.



Рис.5. На фотографии приведен общий вид наклейки ELASTY F plus.

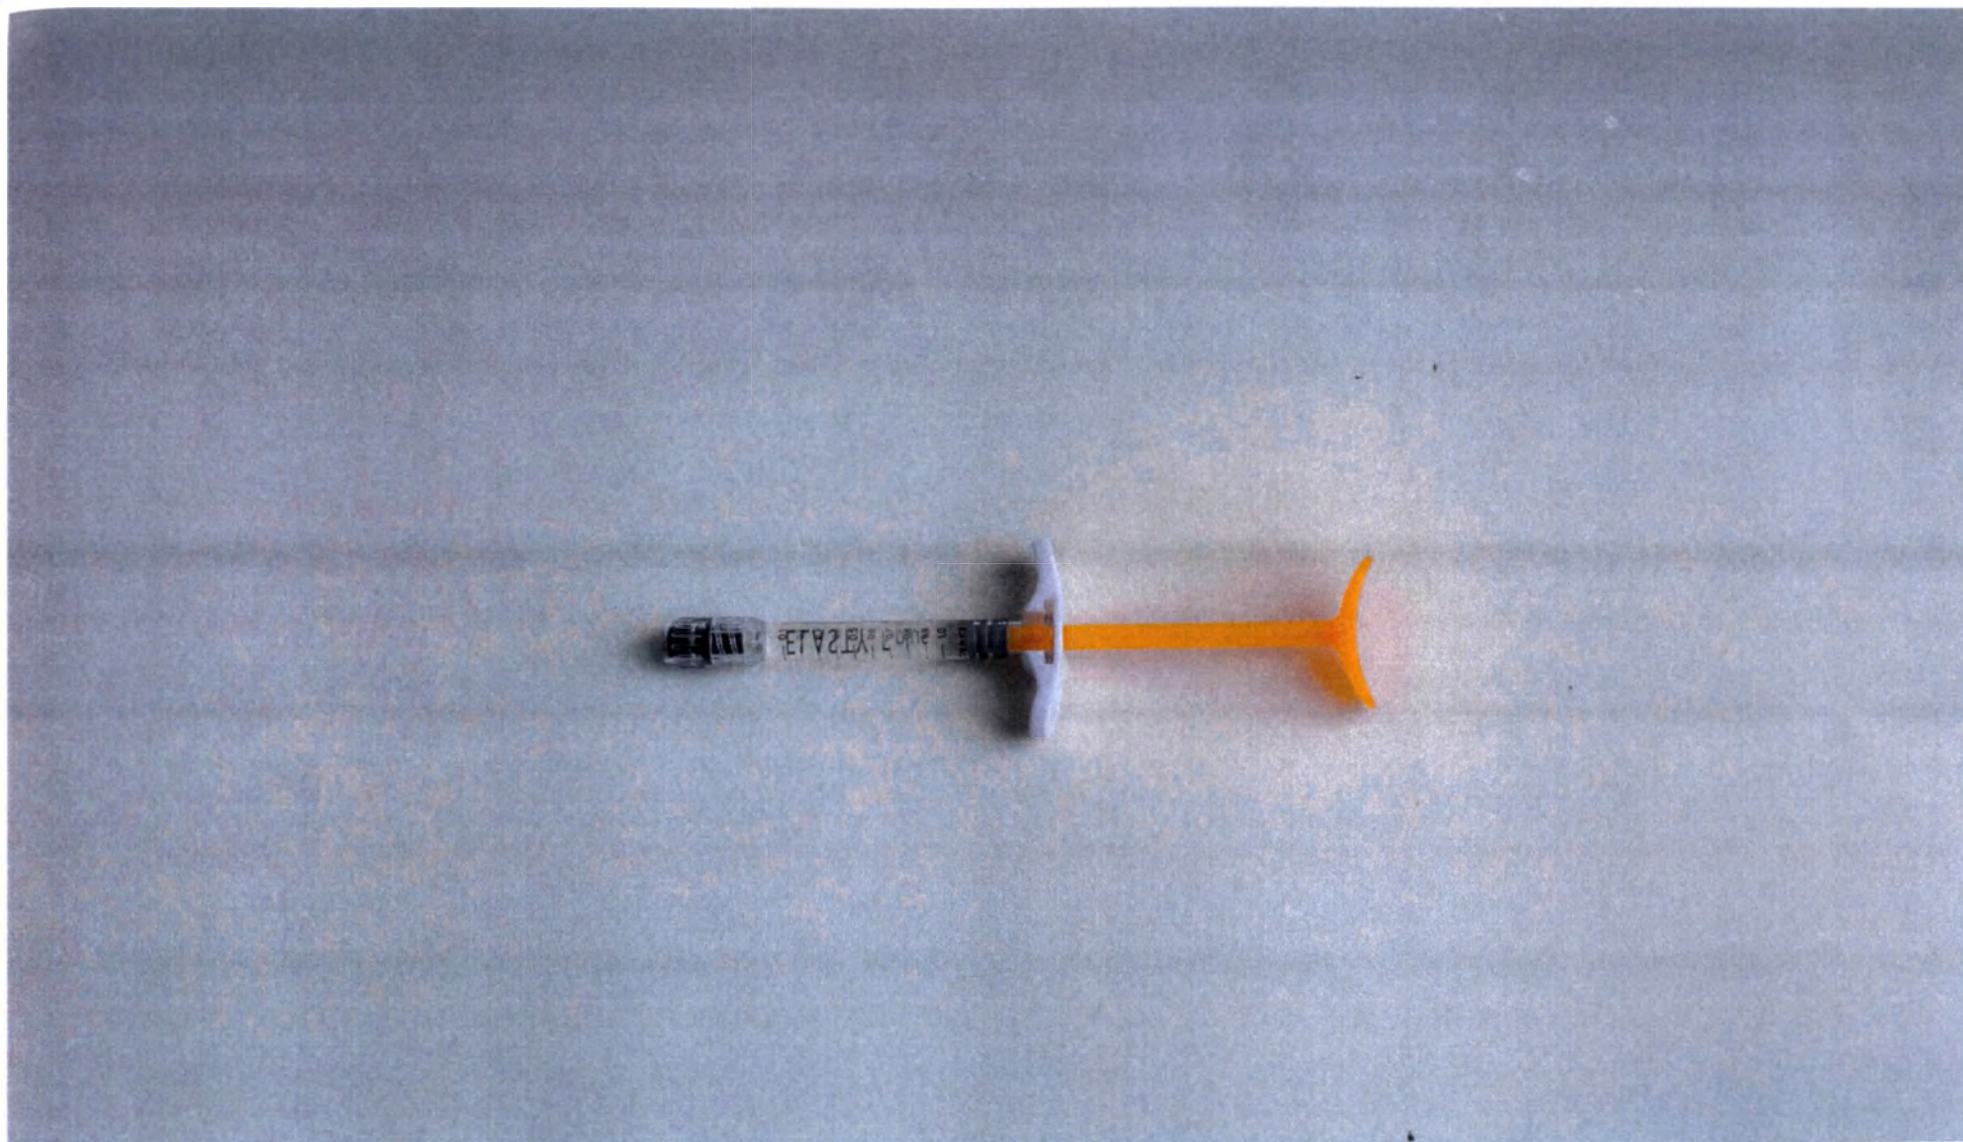


Рис. 6. На фотографии приведен общий вид наполненного шприца ELASTY F plus.

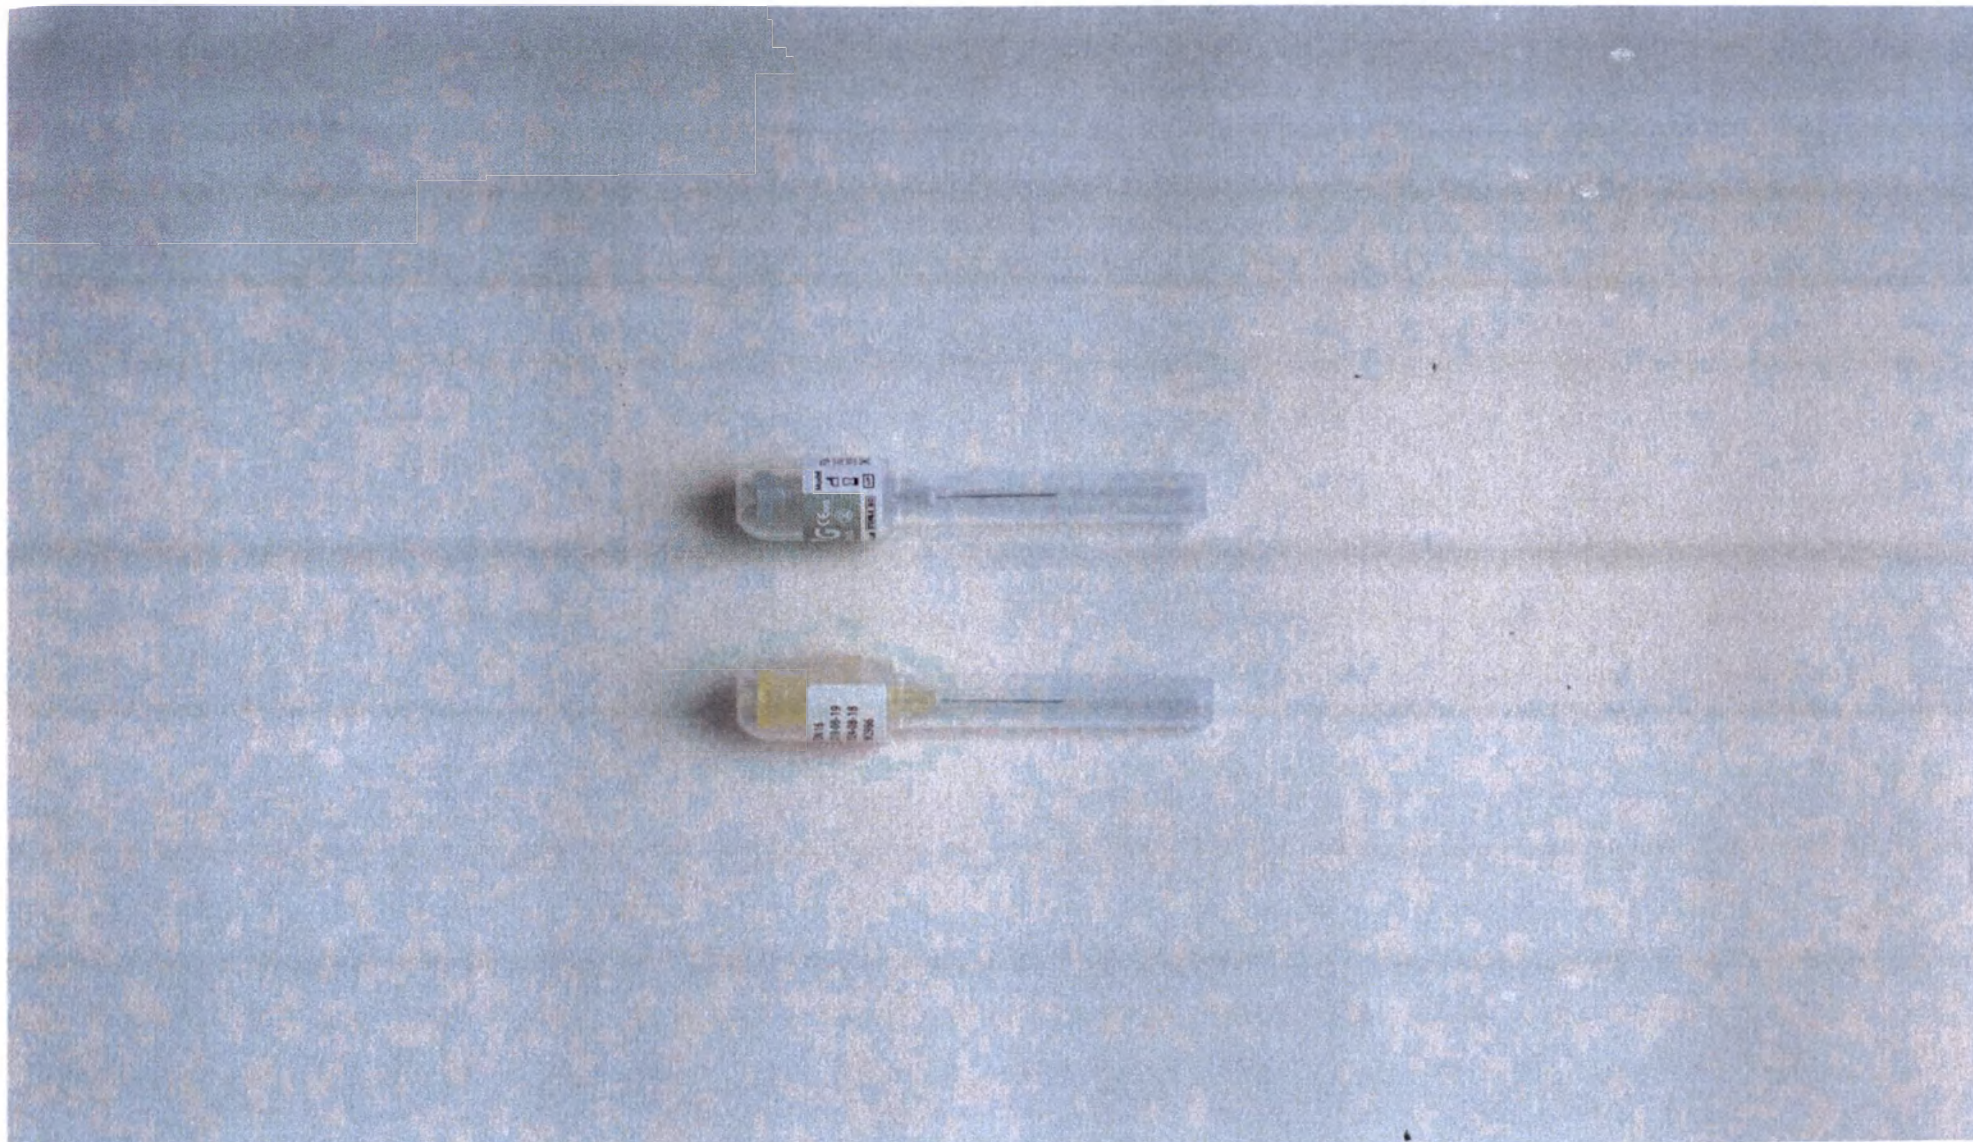


Рис. 7. На фотографии приведен общий вид колпачка с иглой ELASTY F, G, D plus.

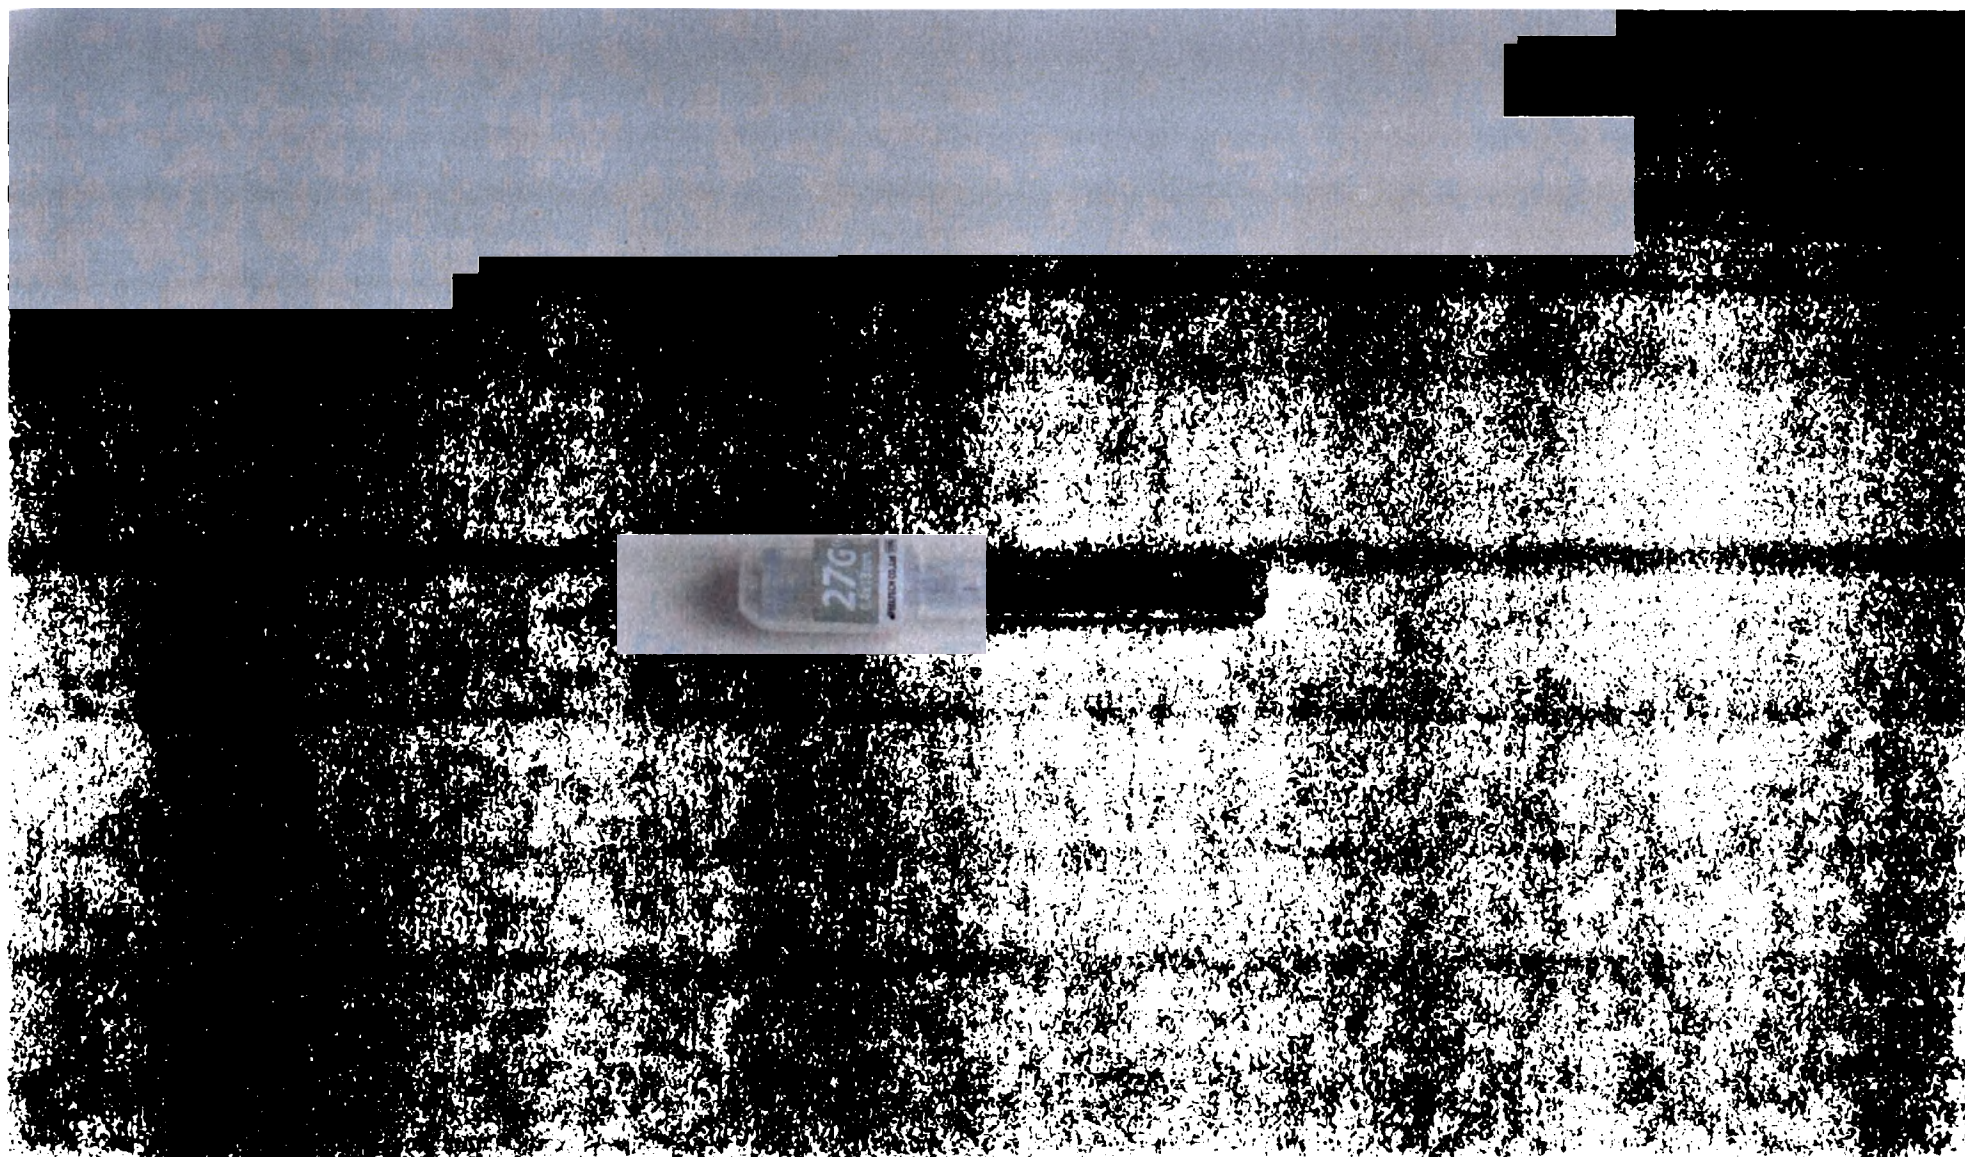


Рис. 8. На фотографии приведен общий вид колпачка с иглой ELASTY F, G, D plus 27G 1/2".

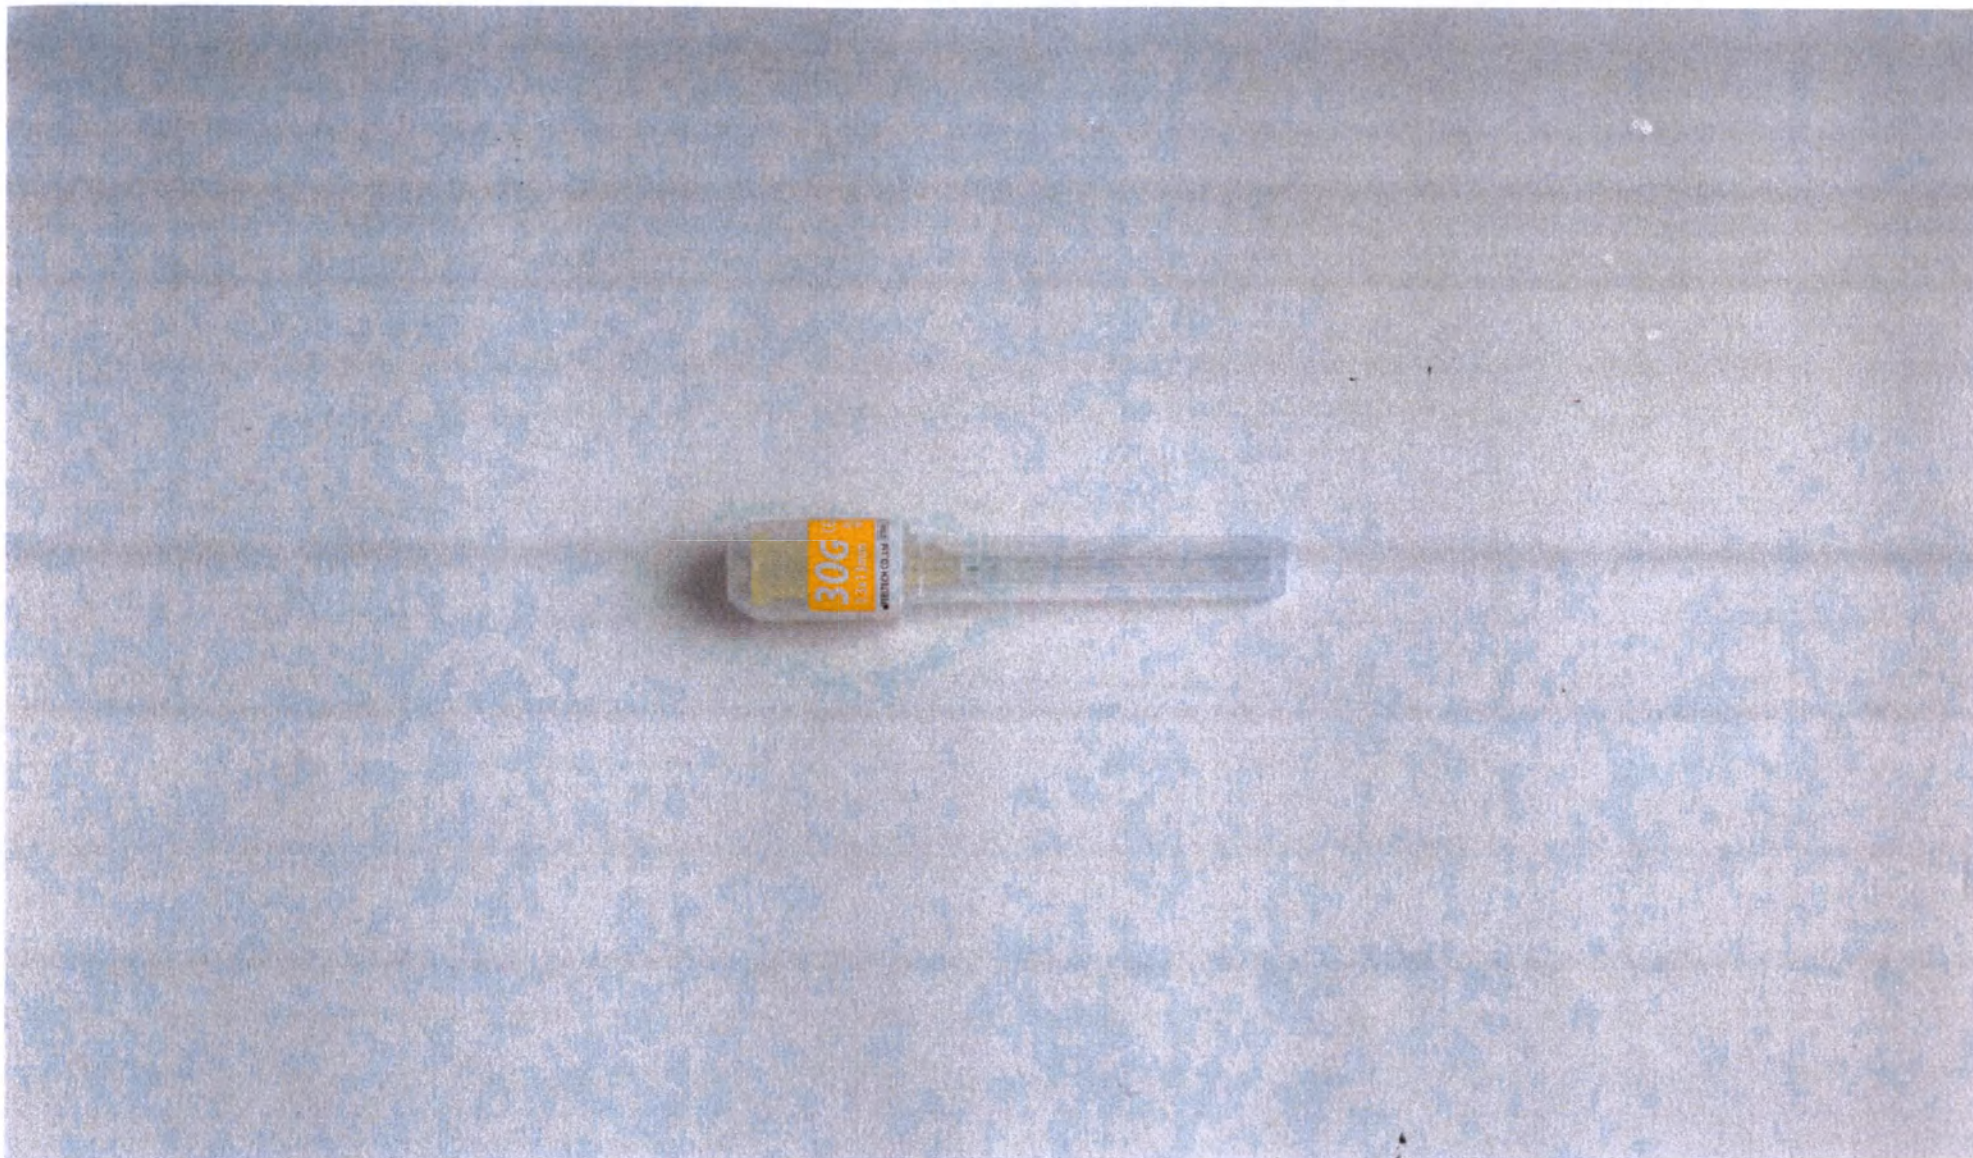


Рис. 9. На фотографии приведен общий вид колпачка с иглой ELASTY F, G, D plus 30G 1/2".

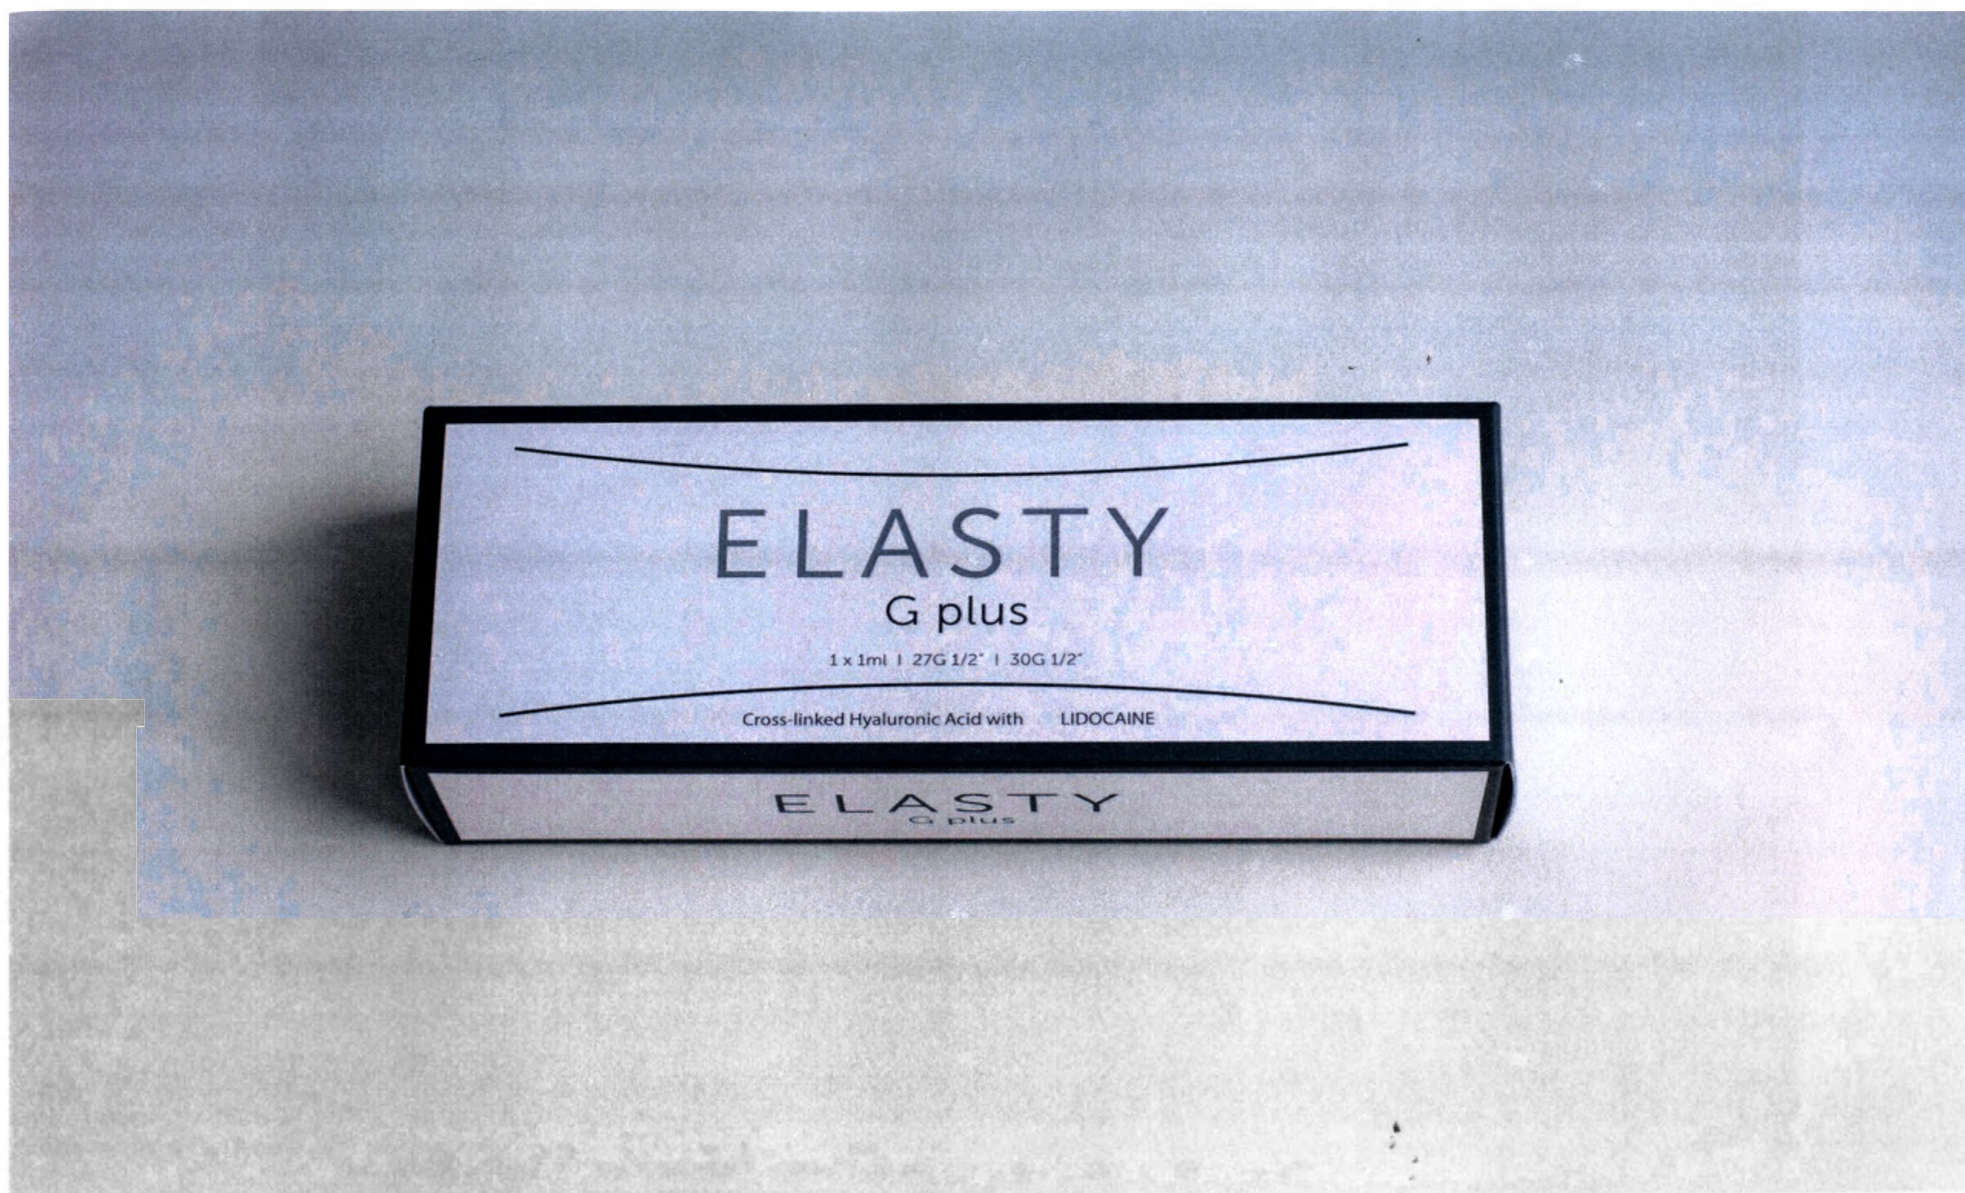


Рис. 10. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны картонной коробки ELASTY G plus.

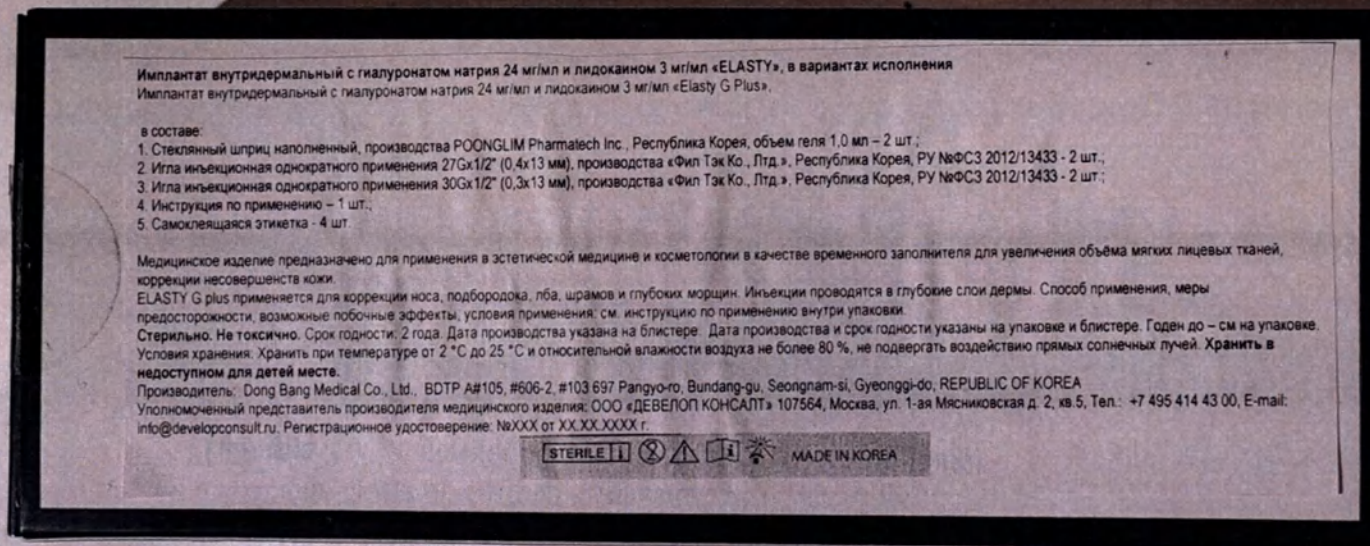


Рис. 11. На фотографии приведен общий вид обратной стороны картонной коробки ELASTY G plus.

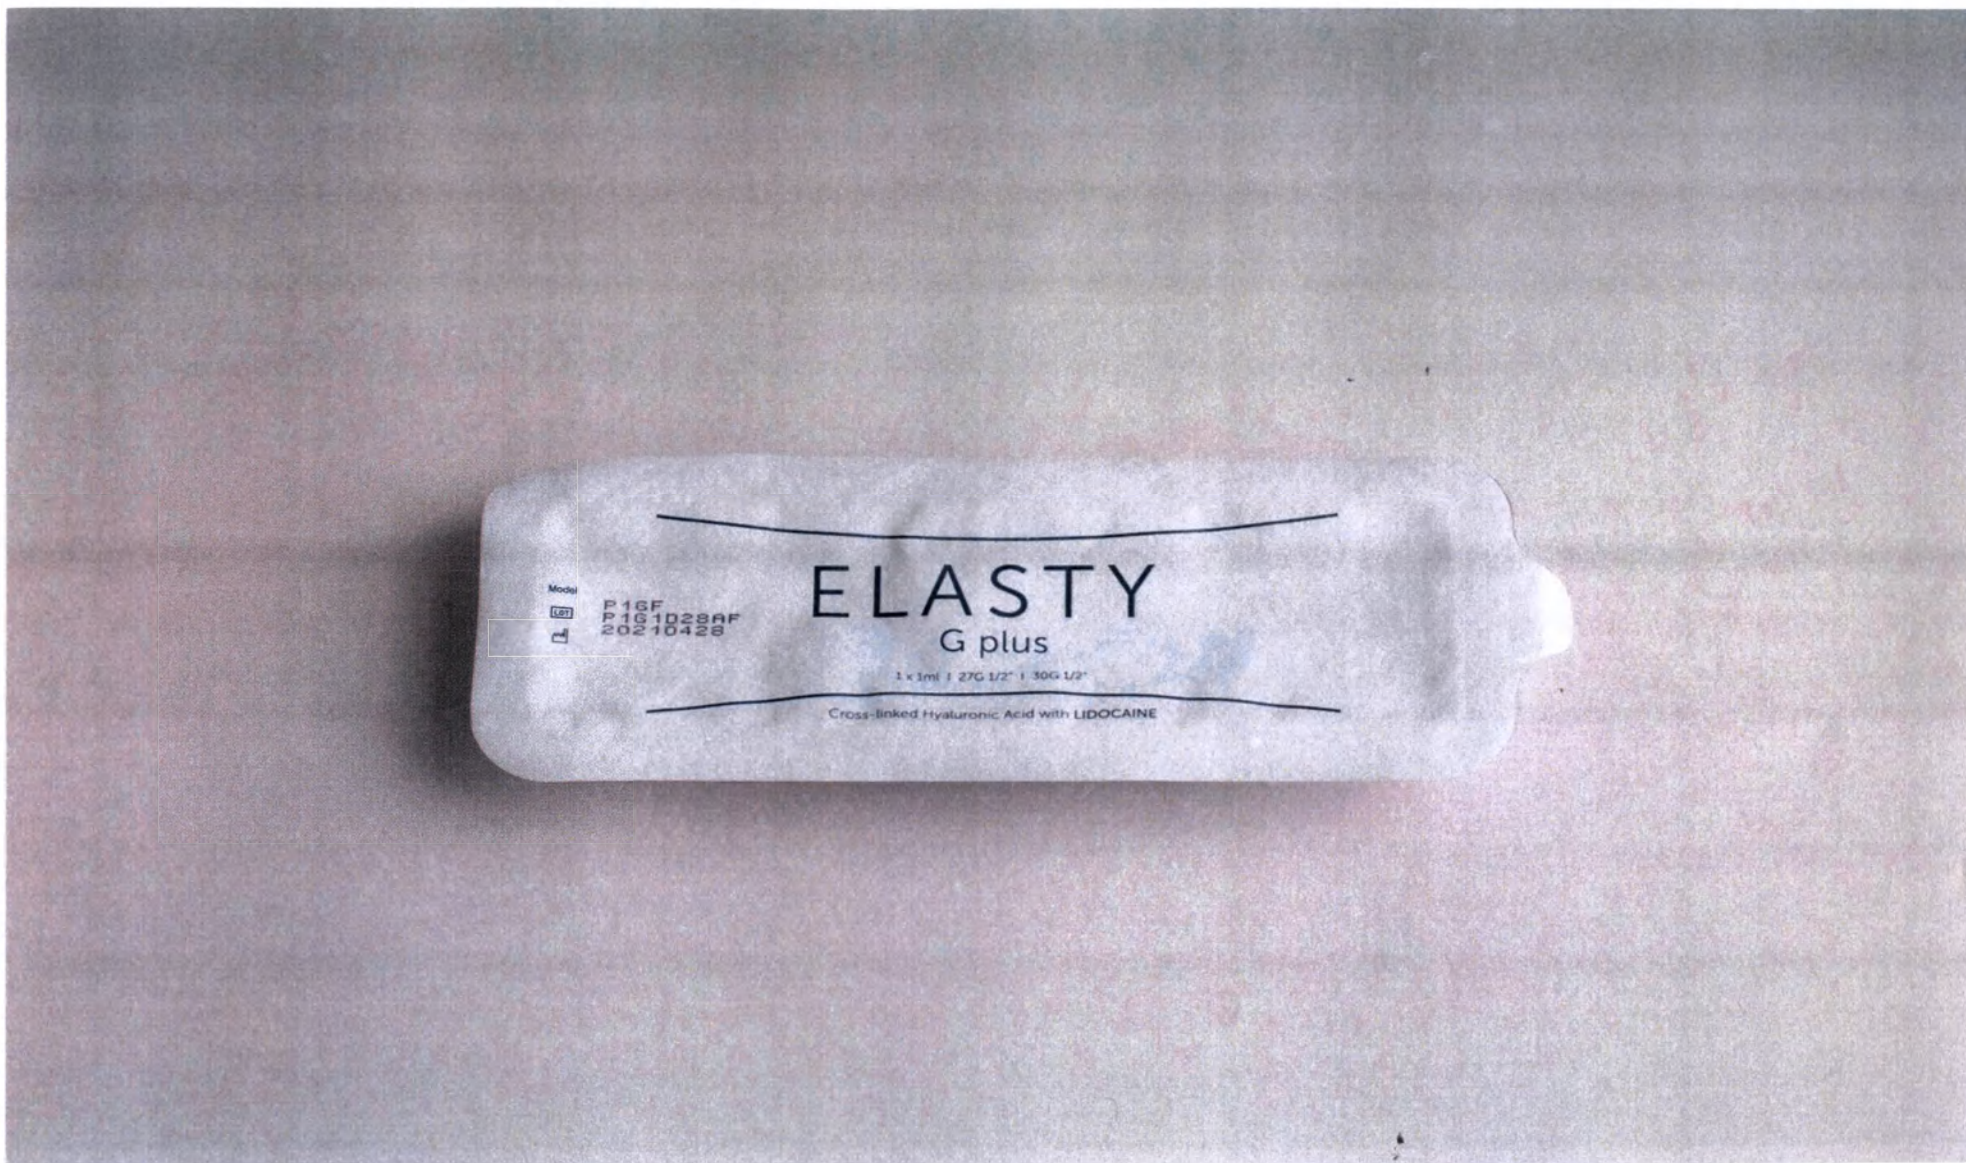


Рис. 12. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны блистера ELASTY G plus.

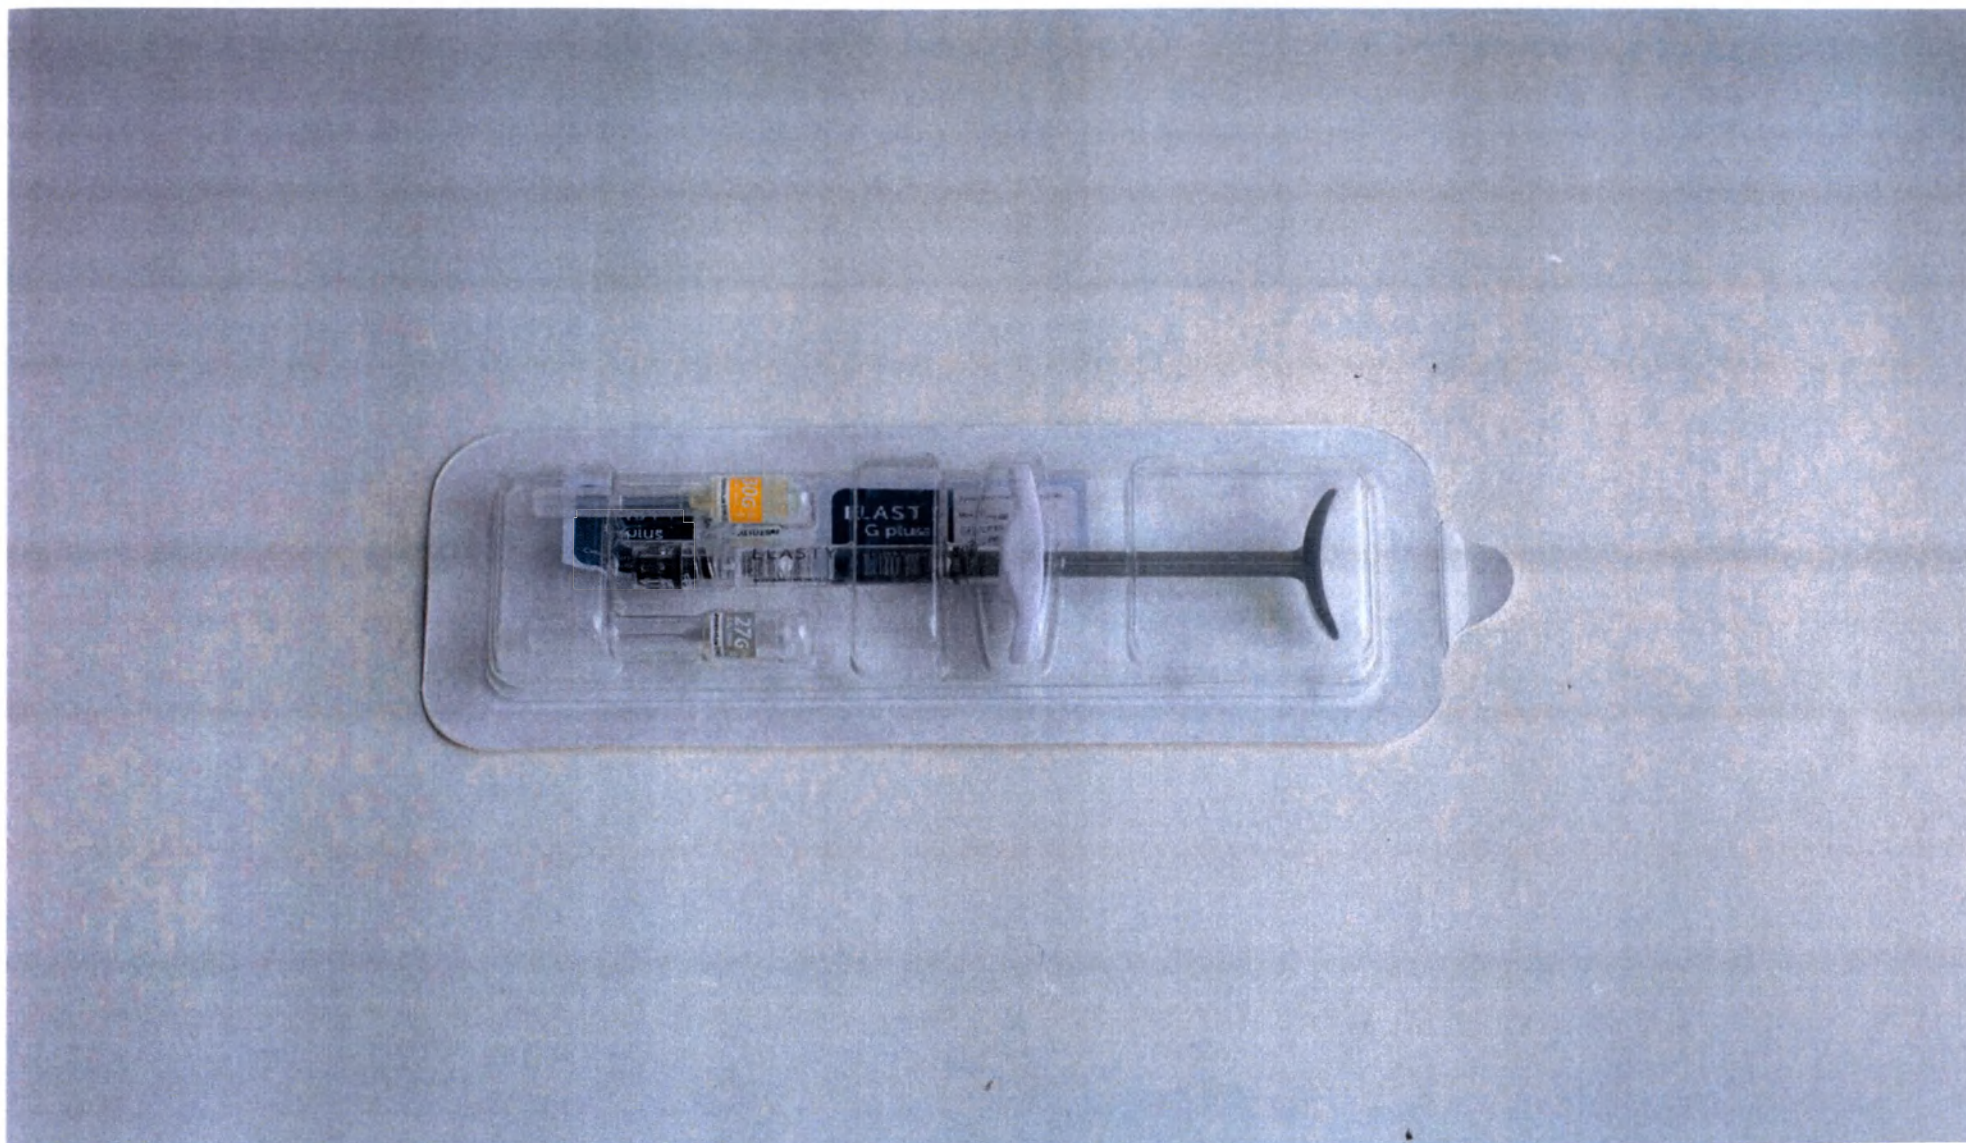


Рис. 13. На фотографии приведен общий вид оборотной стороны блистера ELASTY G plus.

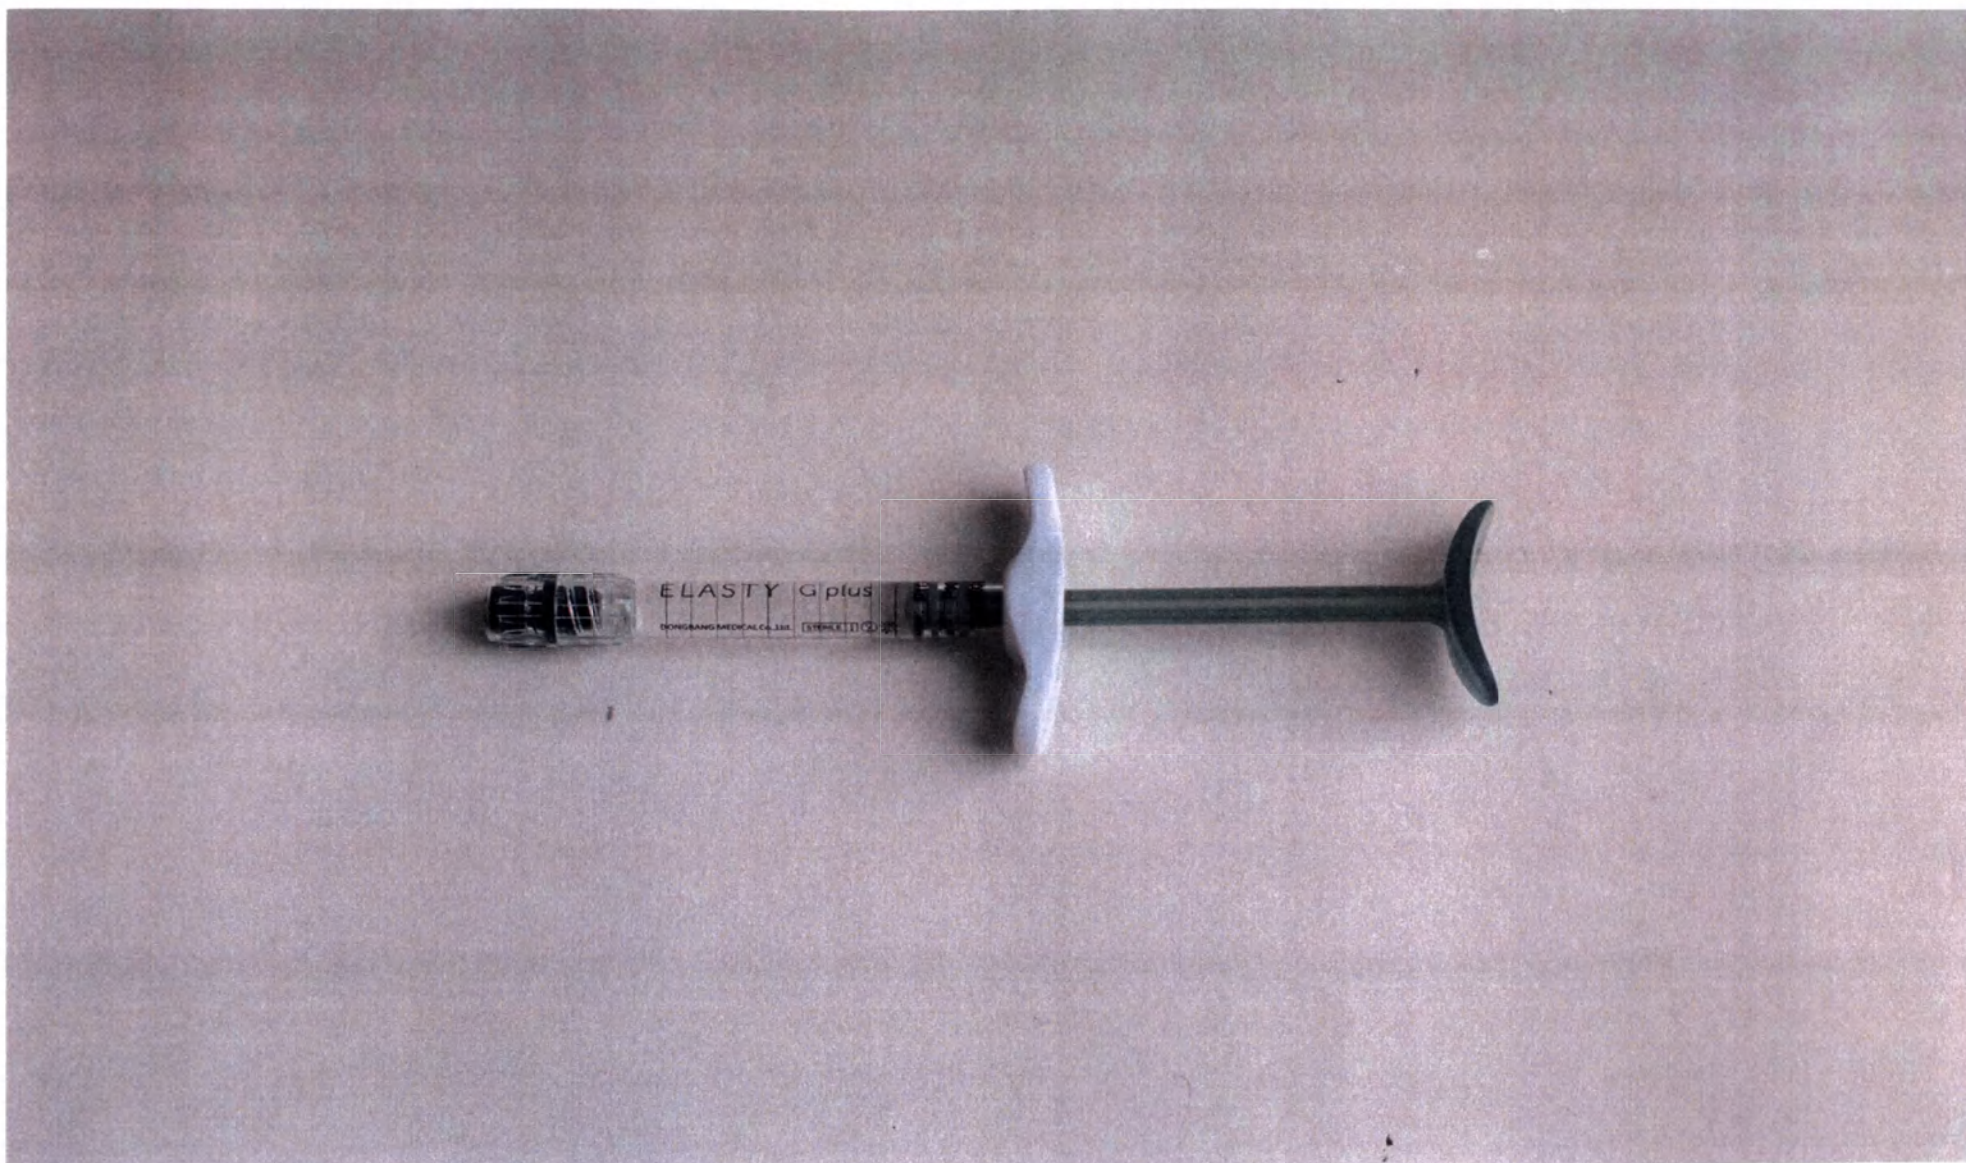


Рис. 14. На фотографии приведен общий вид наполненного шприца ELASTY G plus.



Рис.15. На фотографии приведен общий вид наклейки ELASTY G plus.



Рис. 16. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны картонной коробки ELASTY D plus.

Имплантат внутридермальный с гиалуронатом натрия 24 мг/мл и лидокаином 3 мг/мл «ELASTY», в вариантах исполнения
Имплантат внутридермальный с гиалуронатом натрия 24 мг/мл и лидокаином 3 мг/мл «Elasty D Plus».

в составе:

1. Стекланный шприц наполненный, производства POONGLIM Pharmatech Inc., Республика Корея, объем геля 1,0 мл – 2 шт.;
2. Игла инъекционная однократного применения 27Gx1/2" (0,4x13 мм), производства «Фил Тэк Ко., Лтд.», Республика Корея, РУ №ФСЗ 2012/13433 - 2 шт.;
3. Игла инъекционная однократного применения 30Gx1/2" (0,3x13 мм), производства «Фил Тэк Ко., Лтд.», Республика Корея, РУ №ФСЗ 2012/13433 - 2 шт.;
4. Инструкция по применению – 1 шт.;
5. Самоклеящаяся этикетка - 4 шт.

Медицинское изделие предназначено для применения в эстетической медицине и косметологии в качестве временного заполнителя для увеличения объема мягких лицевых тканей, коррекции несовершенств кожи.

ELASTY G plus применяется для коррекции носа, подбородка, лба, шрамов и глубоких морщин. Инъекции проводятся в глубокие слои дермы. Способ применения, меры предосторожности, возможные побочные эффекты, условия применения: см. инструкцию по применению внутри упаковки.

Стерильно. Не токсично. Срок годности: 2 года. Дата производства и срок годности указаны на упаковке и блистере. Годен до – см на упаковке.

Условия хранения: Хранить при температуре от 2 °C до 25 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. **Хранить в недоступном для детей месте.**

Производитель: Dong Bang Medical Co., Ltd., BDTP A#105, #606-2, #103 697 Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия: ООО «ДЕВЕЛОП КОНСАЛТ» 107564, Москва, ул. 1-ая Мясниковская д. 2, кв.5, Тел.: +7 495 414 43 00, E-mail: info@developconsult.ru. Регистрационное удостоверение: №XXX от XX.XX.XXXX г.


STERILE  MADE IN KOREA

Рис. 17. На фотографии приведен общий вид обратной стороны картонной коробки ELASTY D plus.



Рис. 18. На фотографии приведен общий вид лицевой стороны блистера ELASTY D plus.



Рис. 19. На фотографии приведен общий вид оборотной стороны блистера ELASTY D plus.

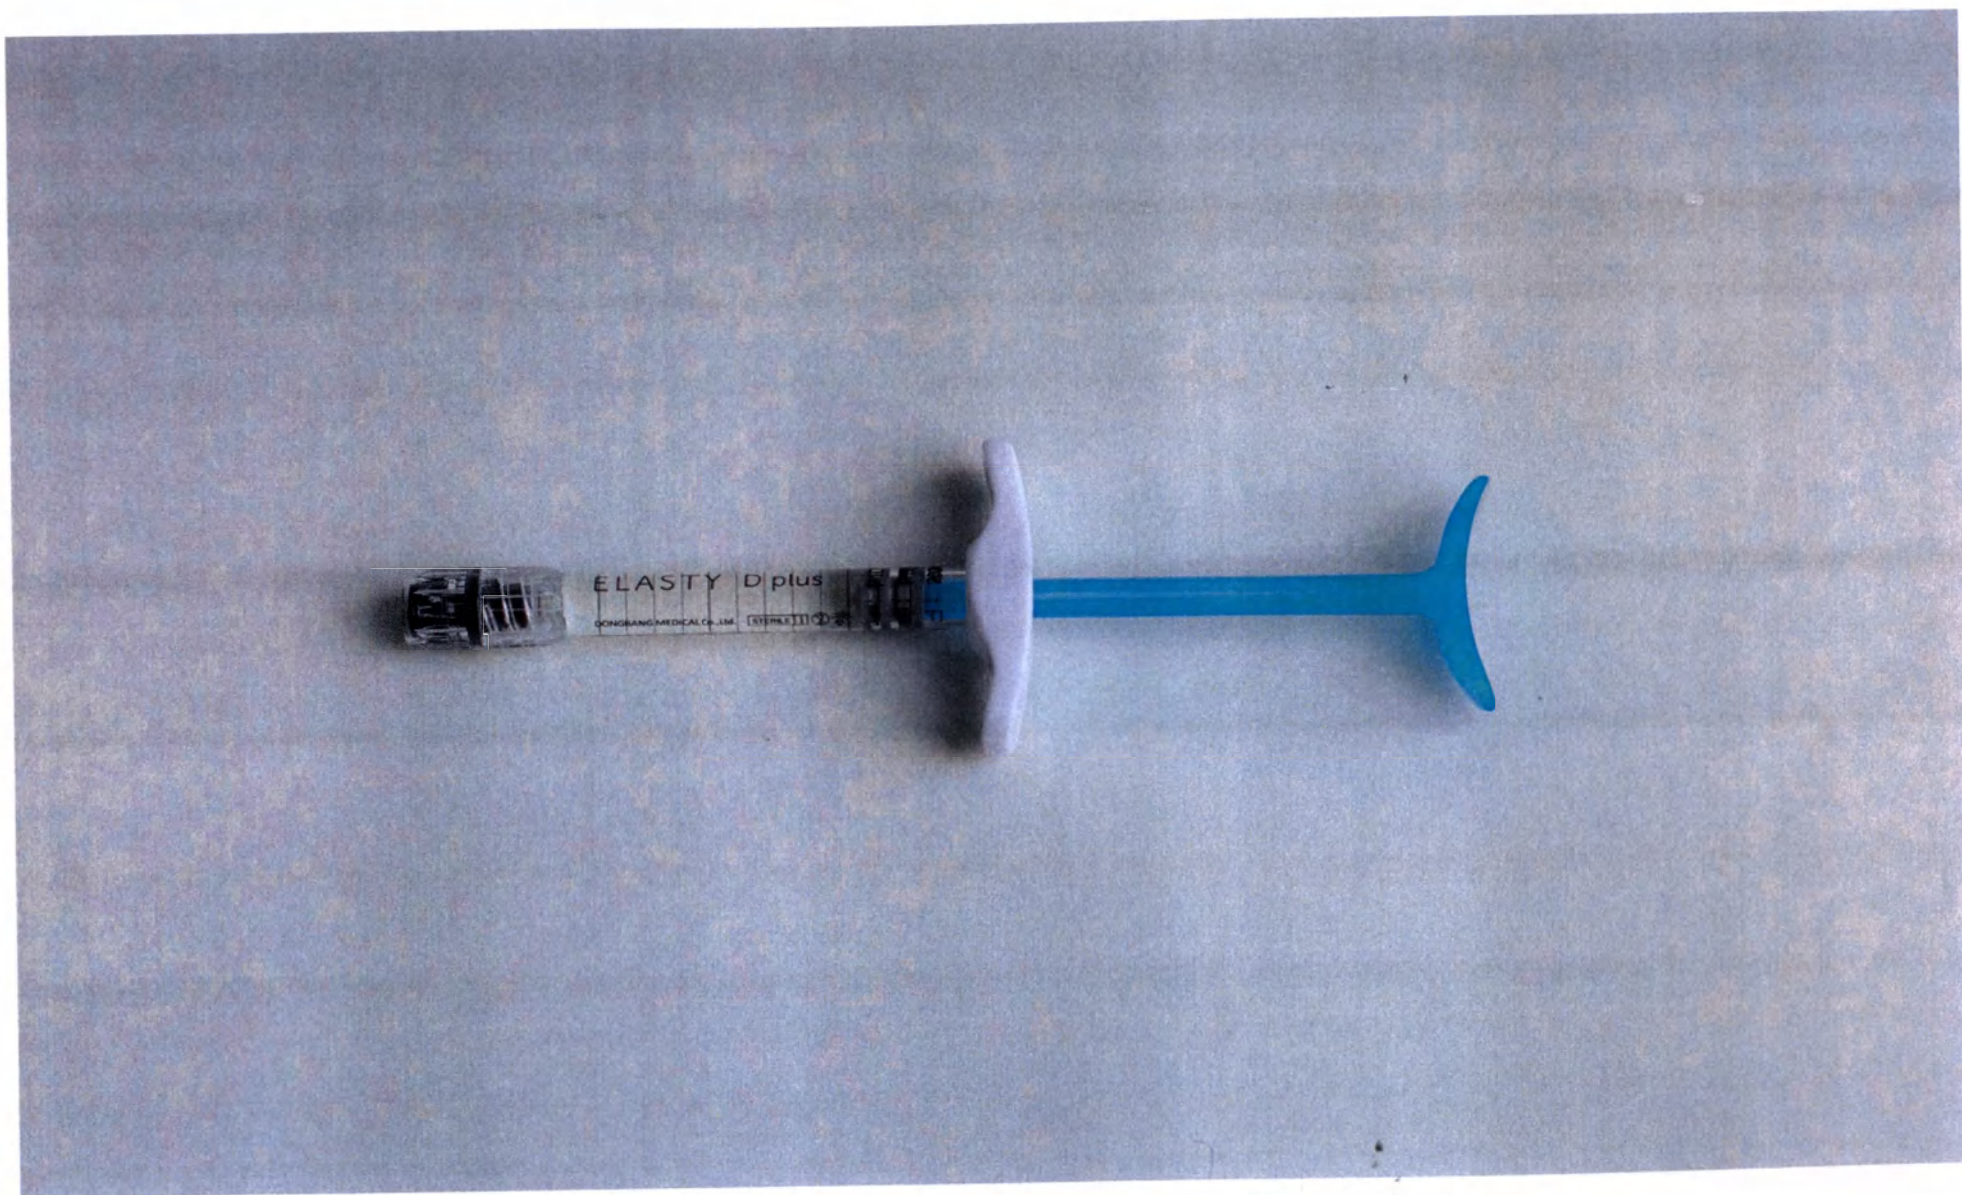


Рис. 20. На фотографии приведен общий вид наполненного шприца ELASTY D plus.



Рис.21. На фотографии приведен общий вид наклейки ELASTY D plus.



Рис. 22. Фото транспортной упаковки с маркировкой

Прошито и пронумеровано 2

скреплено печатью
Генеральный директор
ООО «ДЕВЕЛОП КОНСА

А.М. Т

МП

» 202

