

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ВИТА»



Чайс Н.Н.


20 23 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


СТОЛ МЕДИЦИНСКИЙ

по ТУ 32.50.30-003-48837523-2019


Стол медицинский одностумбовый с дверью (Арт. СЛ-001)

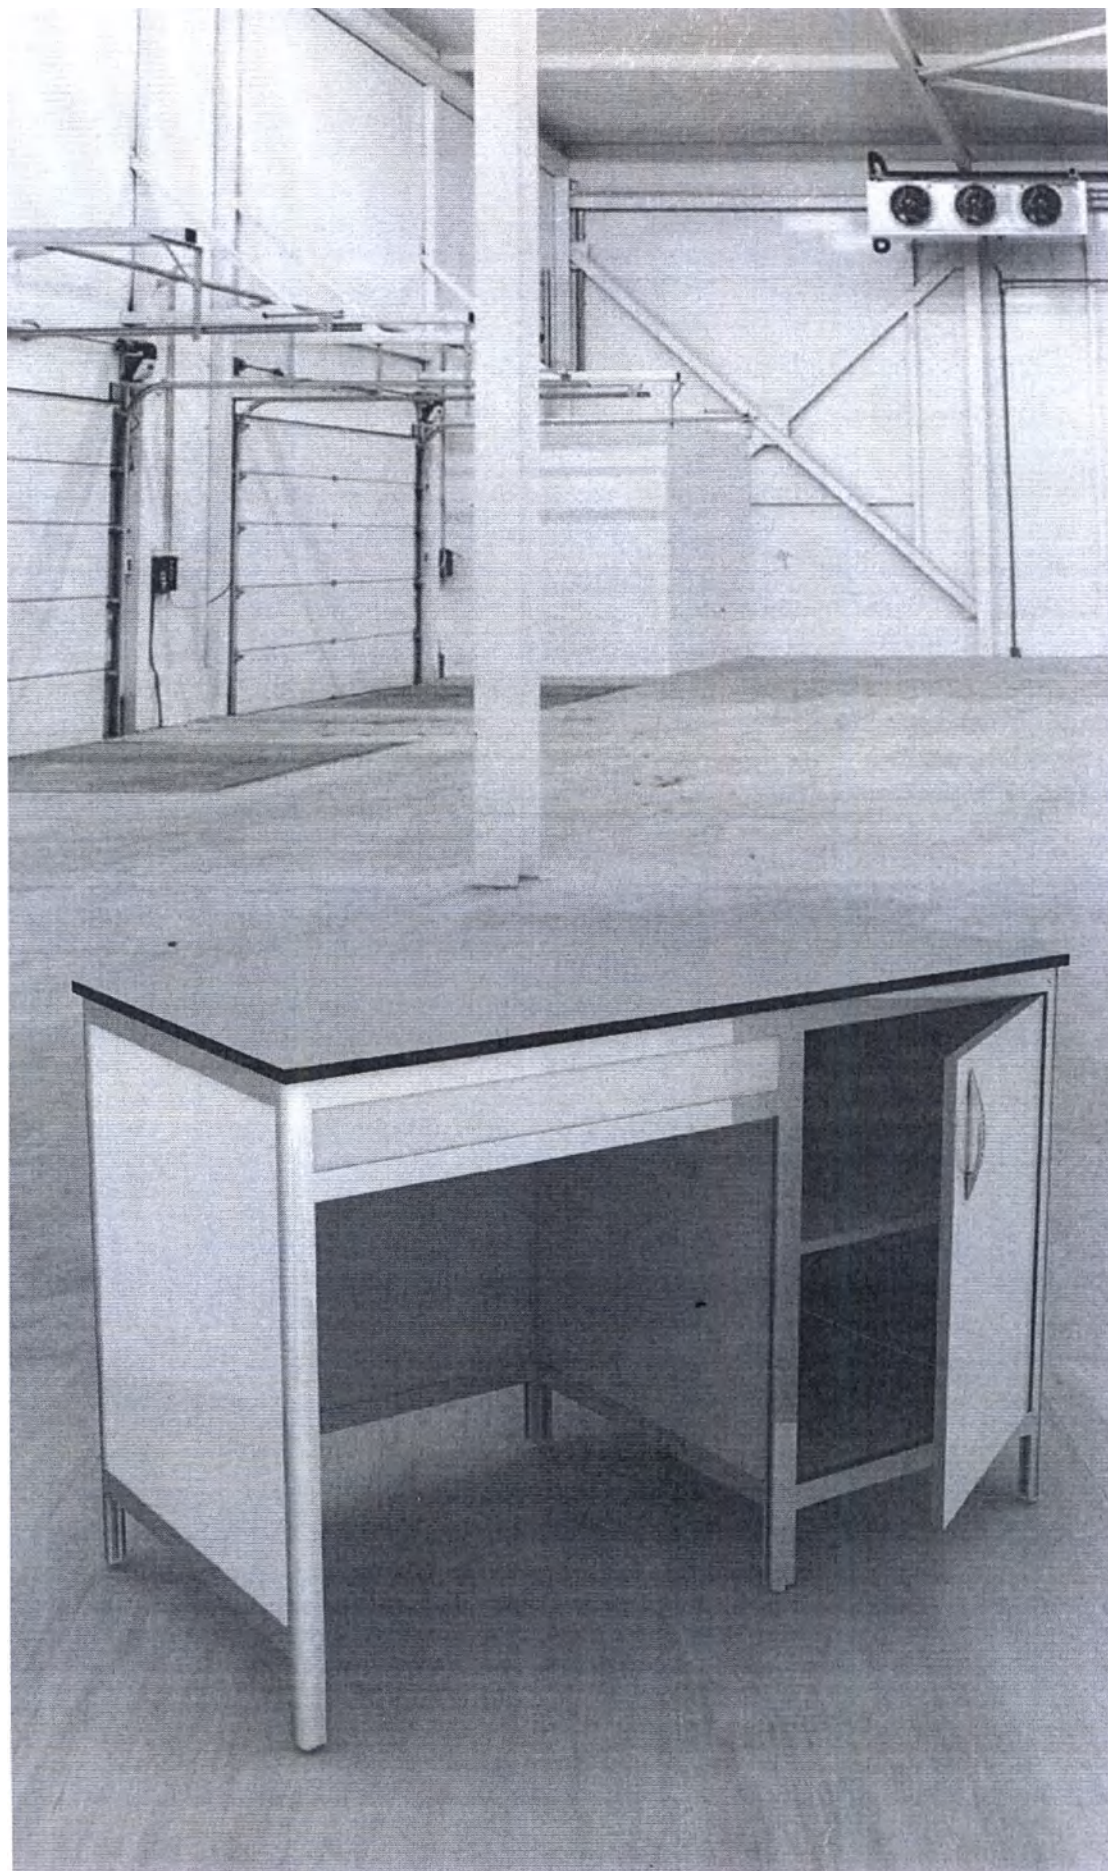


Стол медицинский одностумбовый с четырьмя выдвижными ящиками (Арт. СЛ-002)

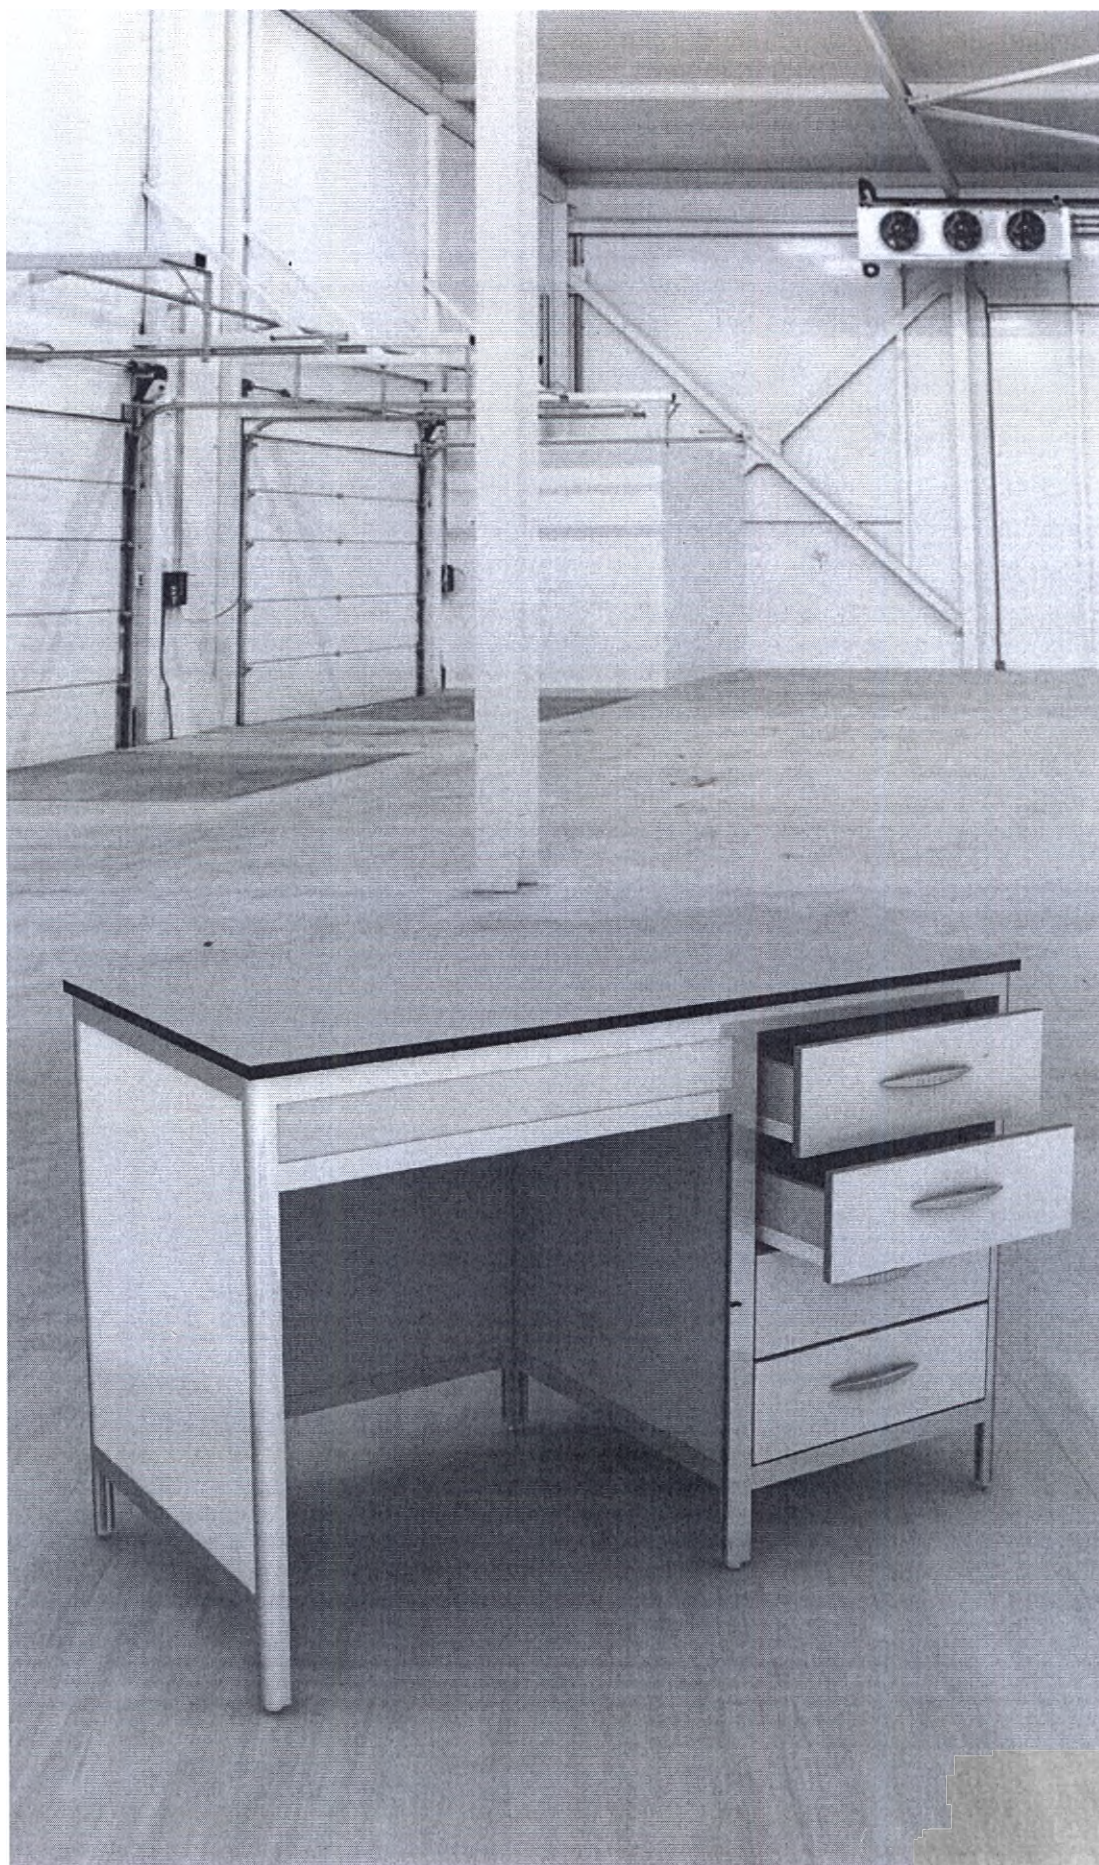


Стол медицинский одностумбовый с выдвижным ящиком и дверью (Арт. СЛ-003)

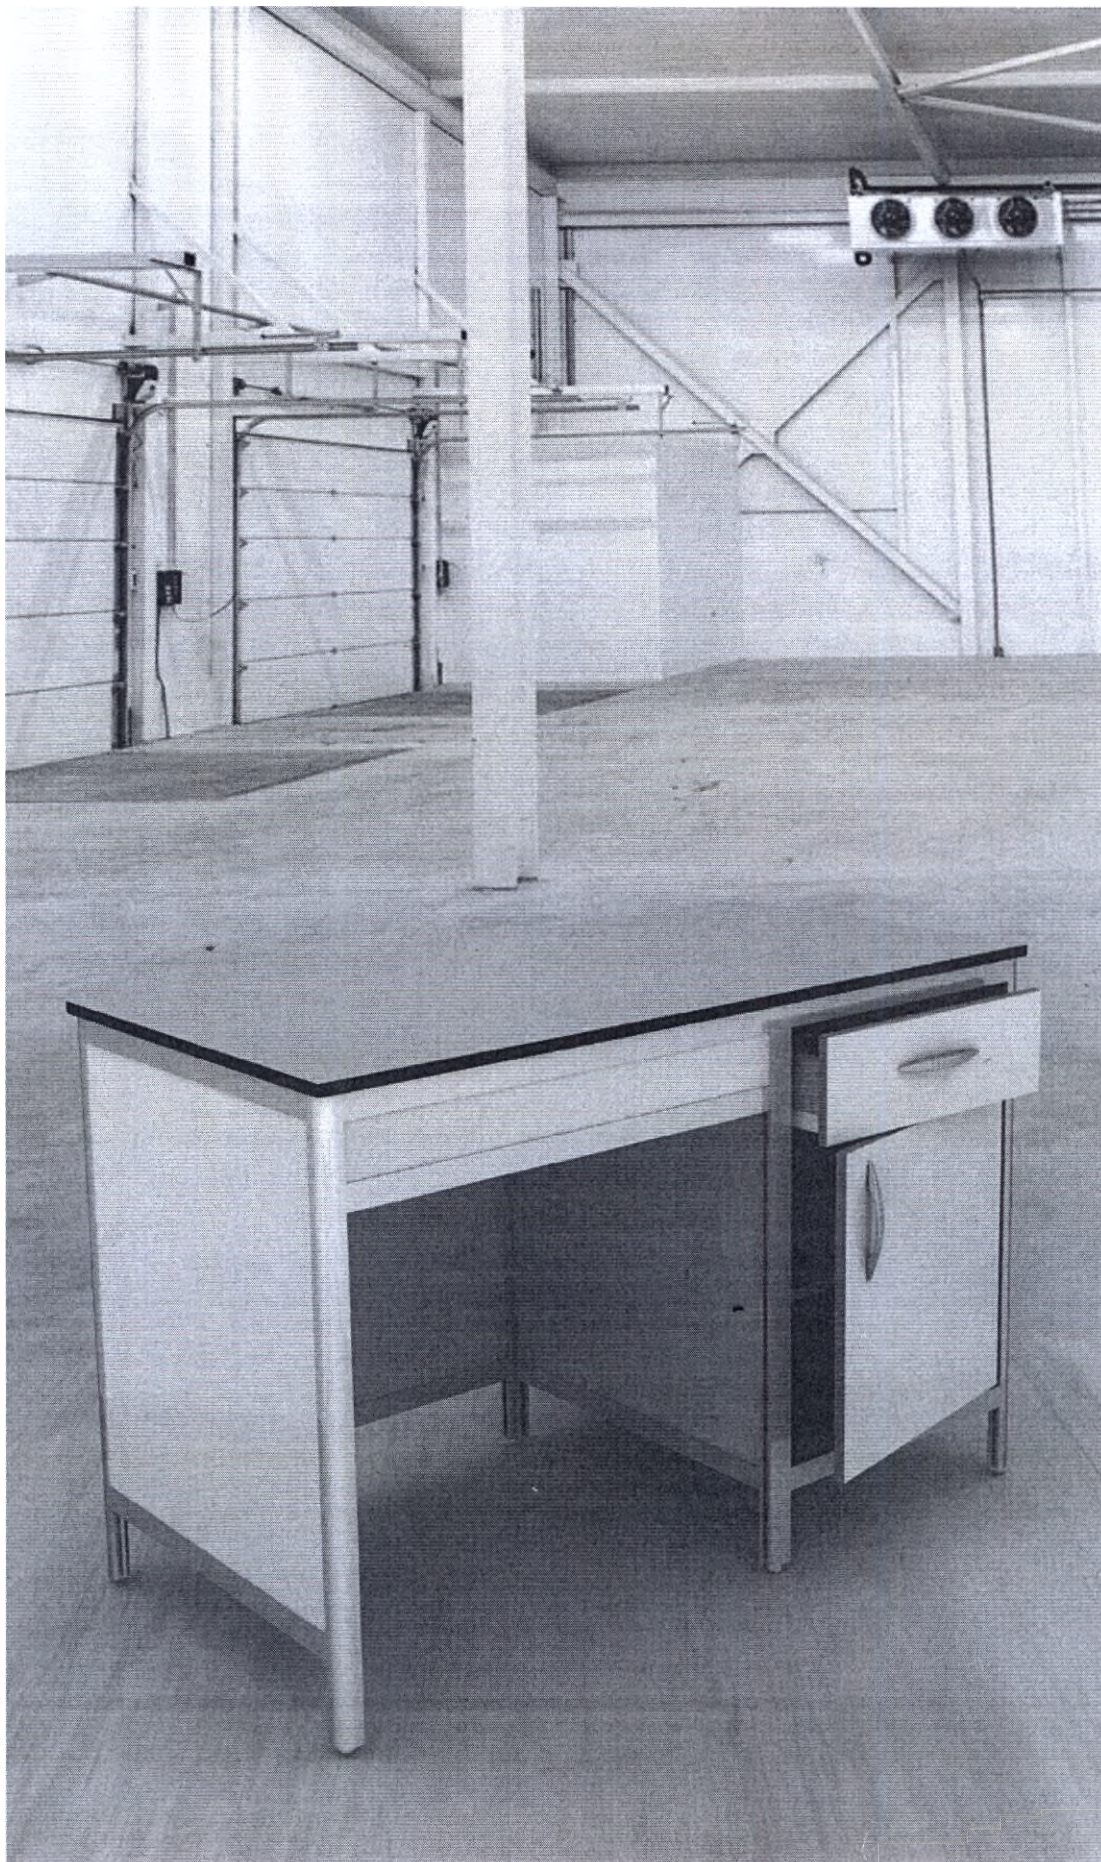


Стол медицинский с двумя выдвижными ящиками (Арт. СЛ-004)

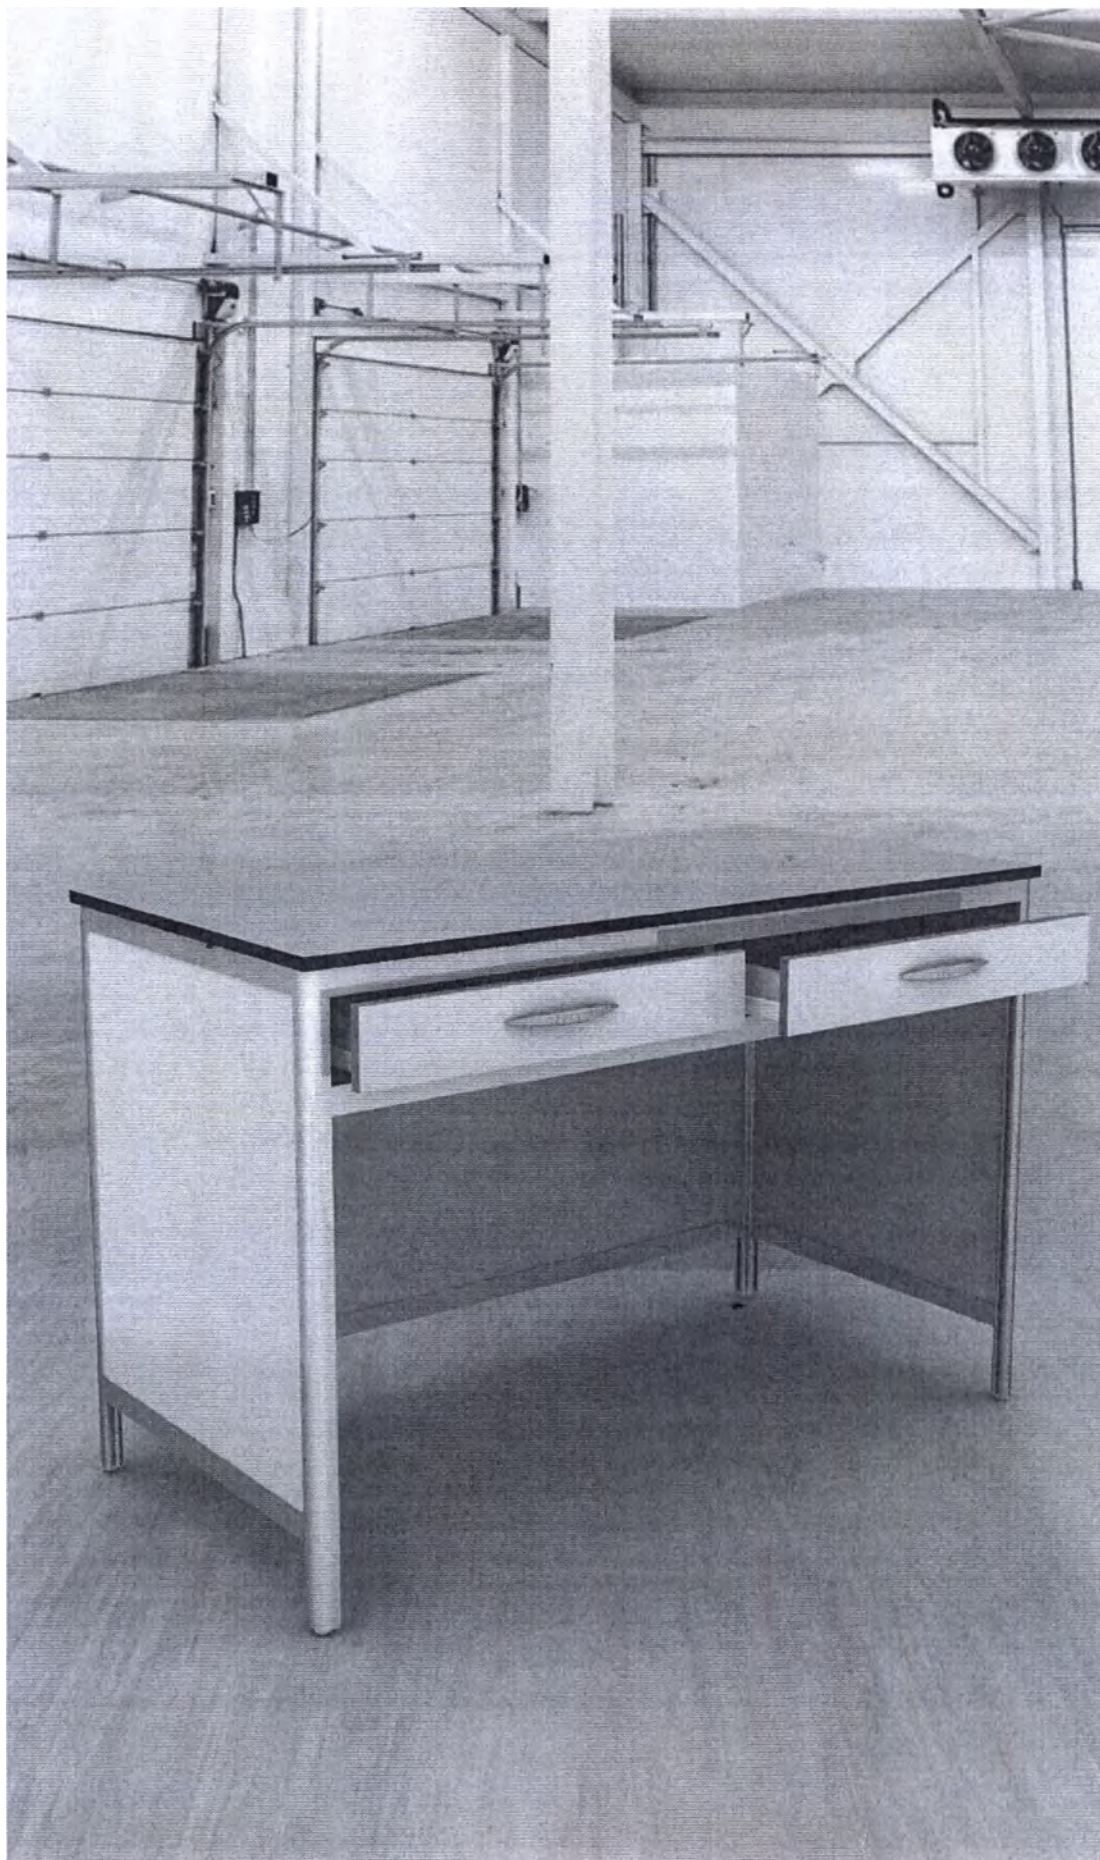

Стол медицинский рабочий (Арт. СЛ-005)

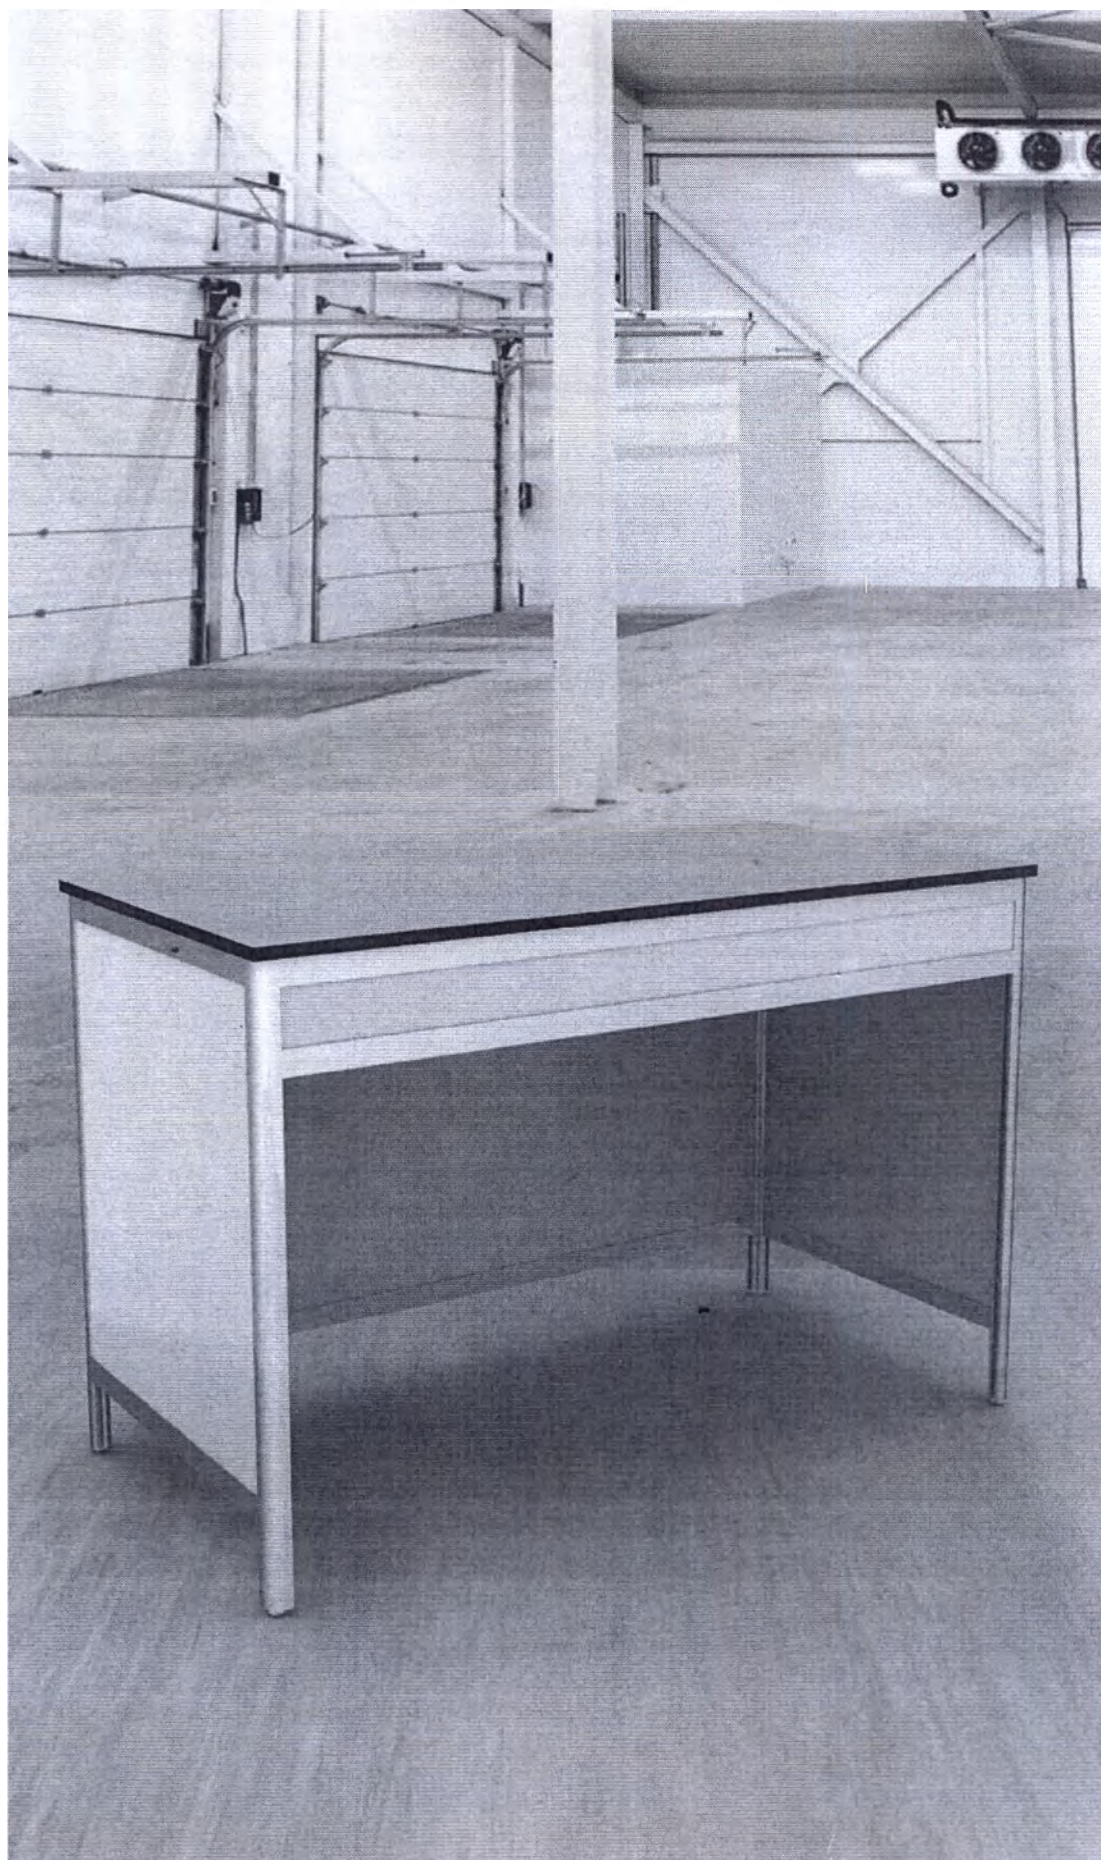


Стол медицинский с перегородкой (Арт. СЛ-006)

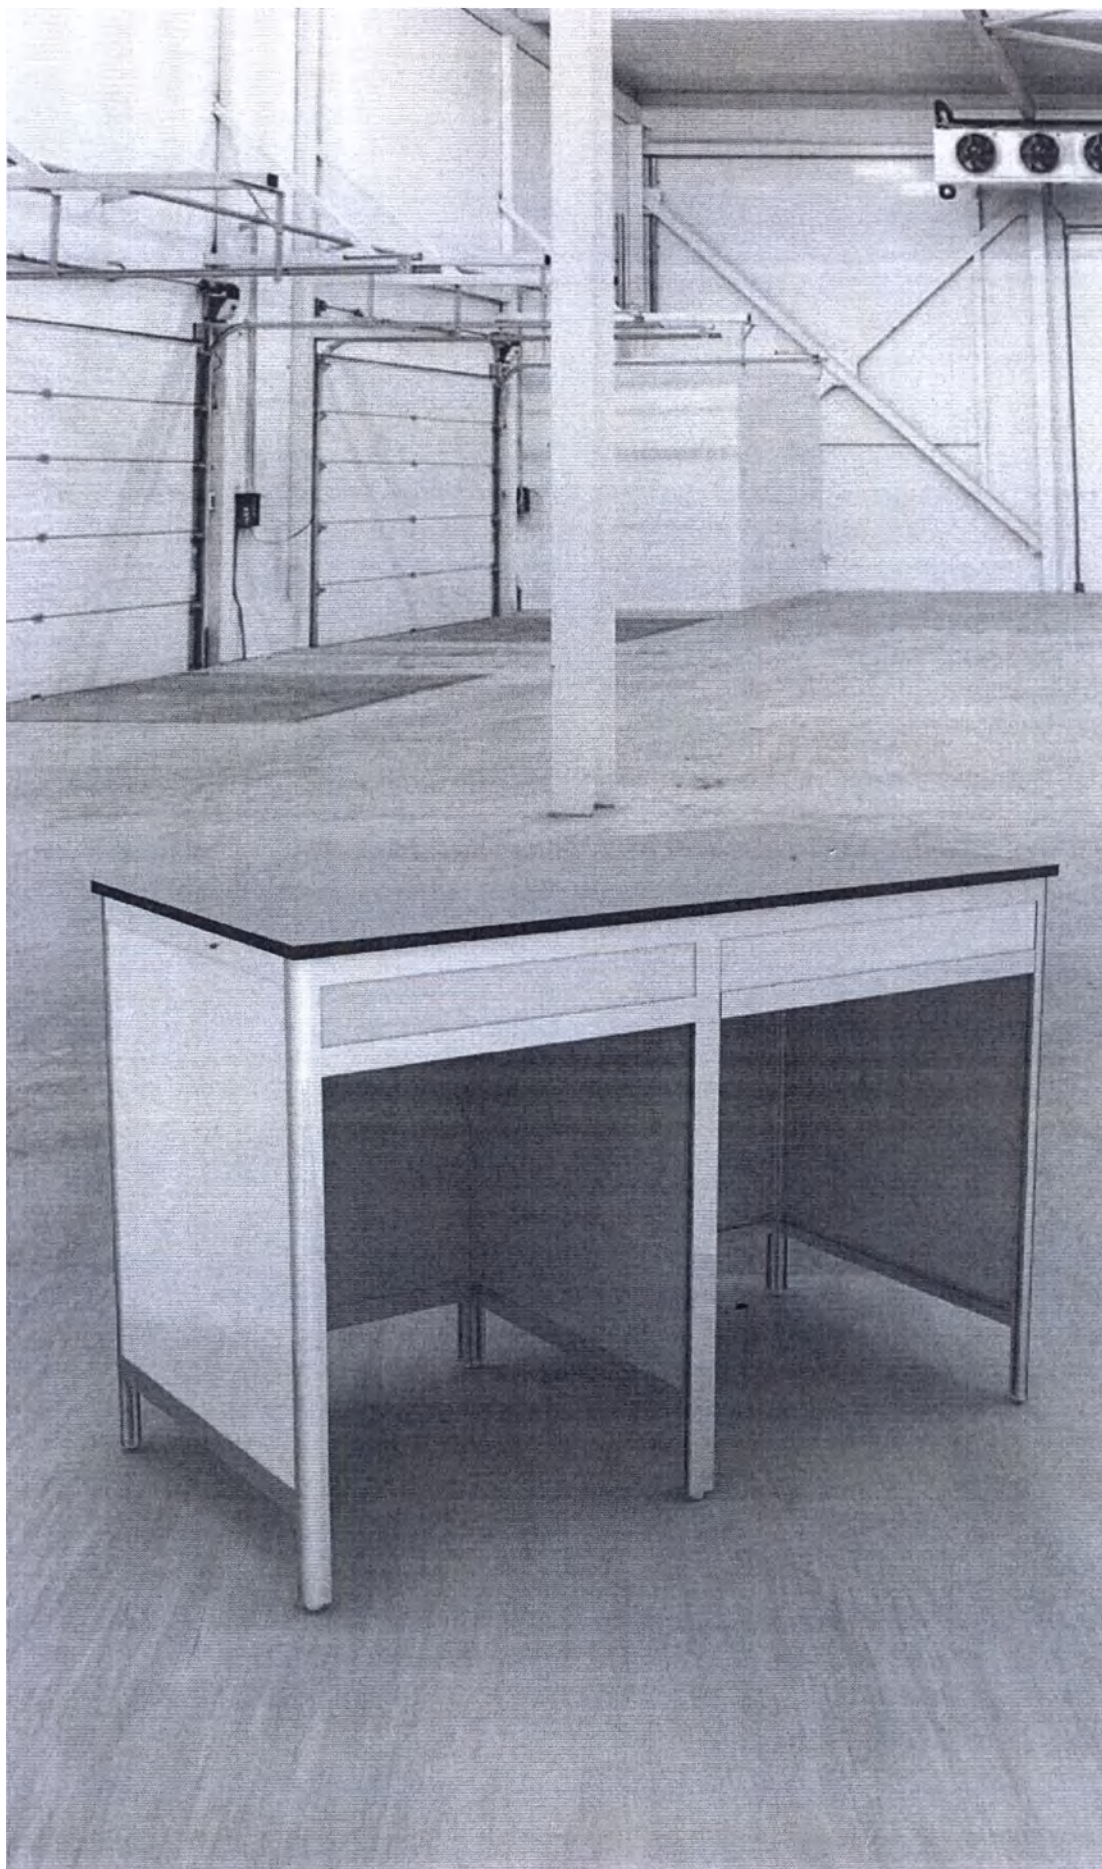


Стол медицинский двухтумбовый с четырьмя выдвижными ящиками и дверью
(Арт. СЛ-007)



Стол медицинский двухтумбовый (Арт. СЛ-008)

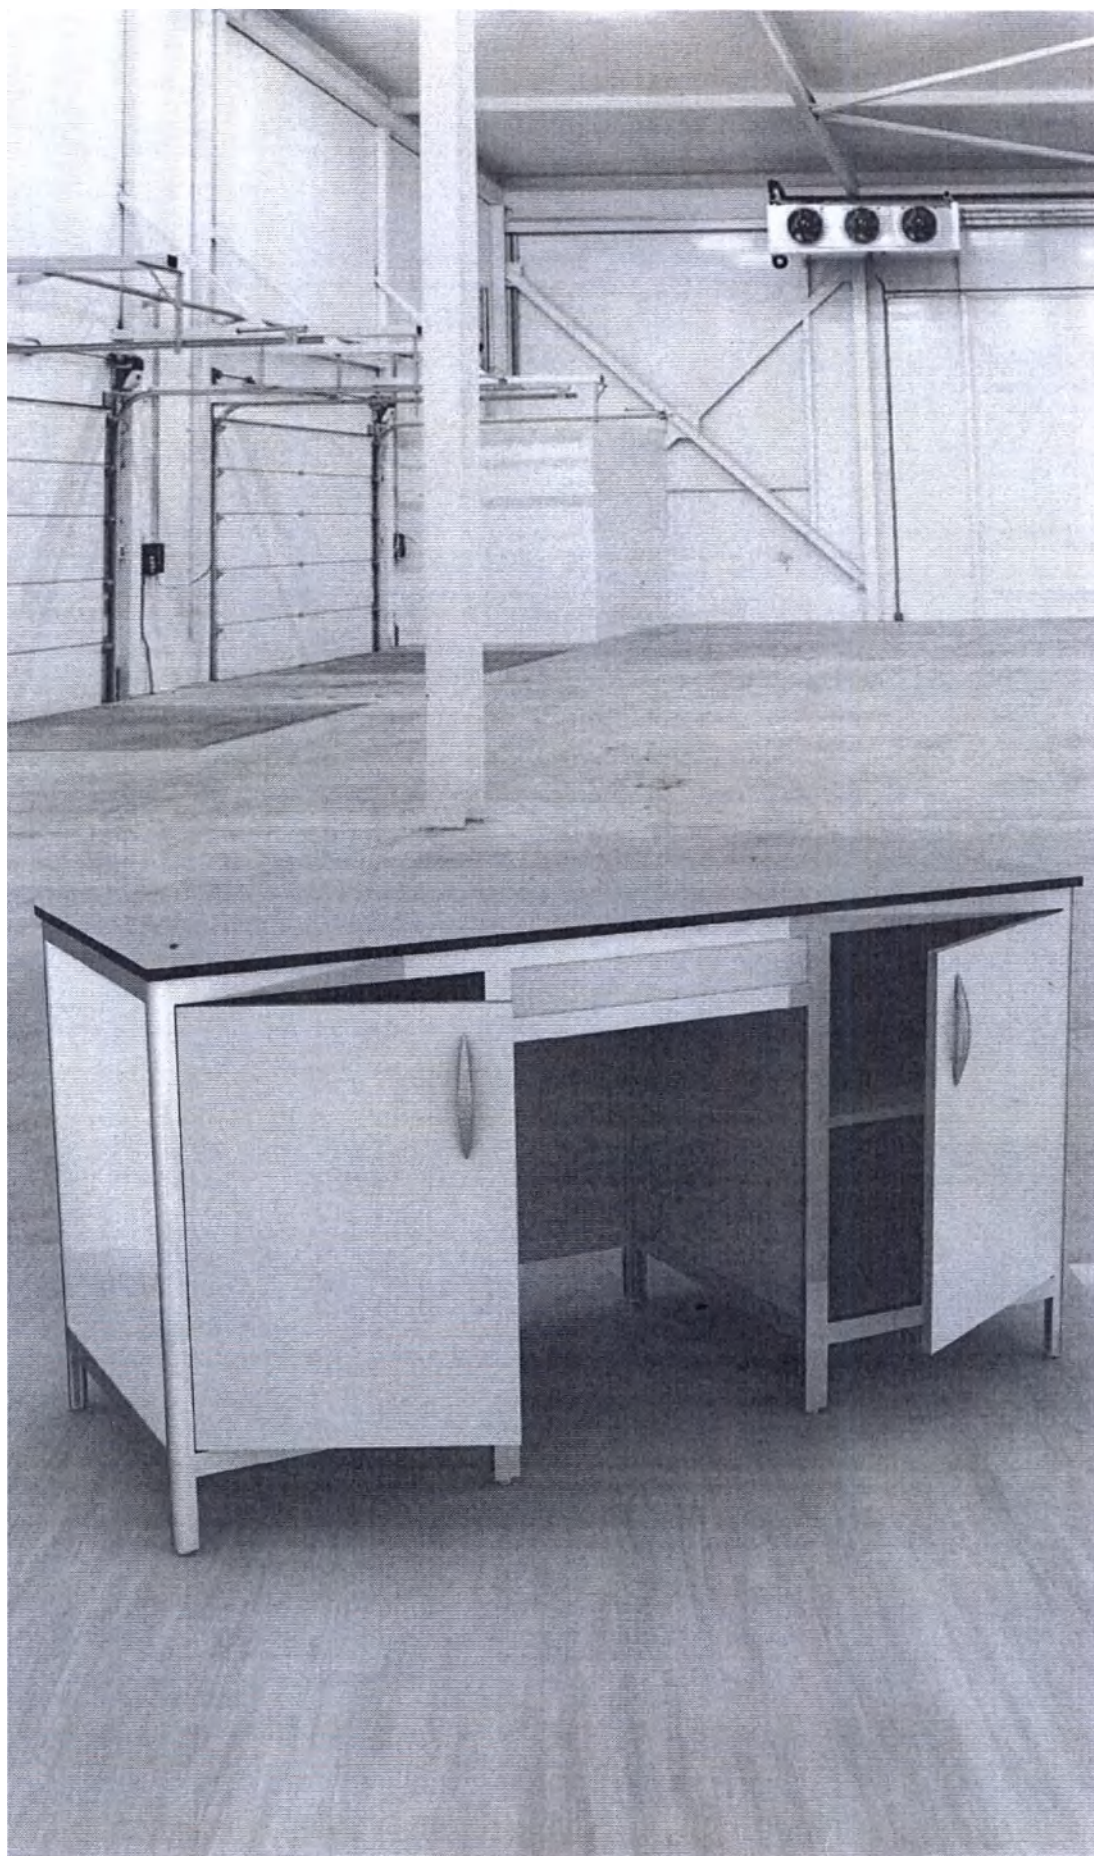


Стол медицинский угловой с усиленной столешницей (Арт. СЛ-009)

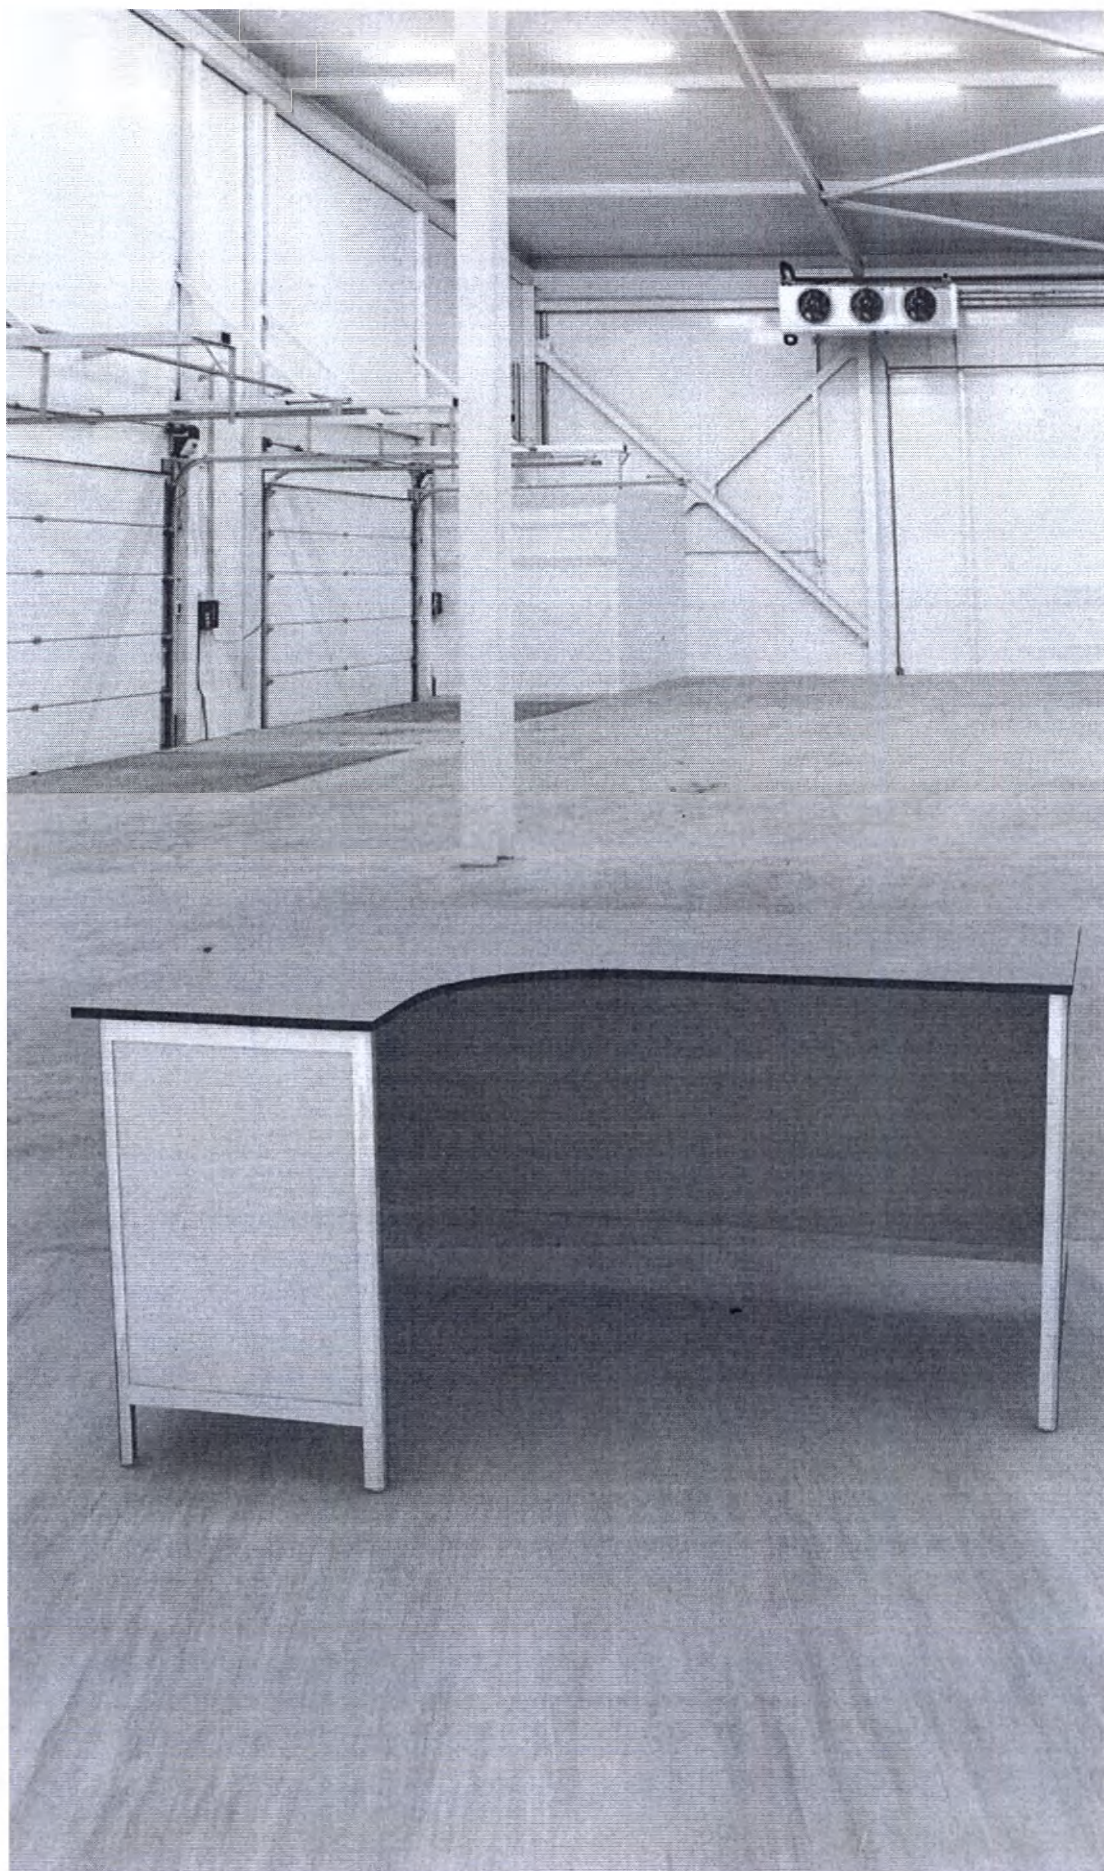


Стол медицинский с бортиками (Арт. СЛ-010)



Стол медицинский для работы с микроскопом (Арт. СЛ-011)

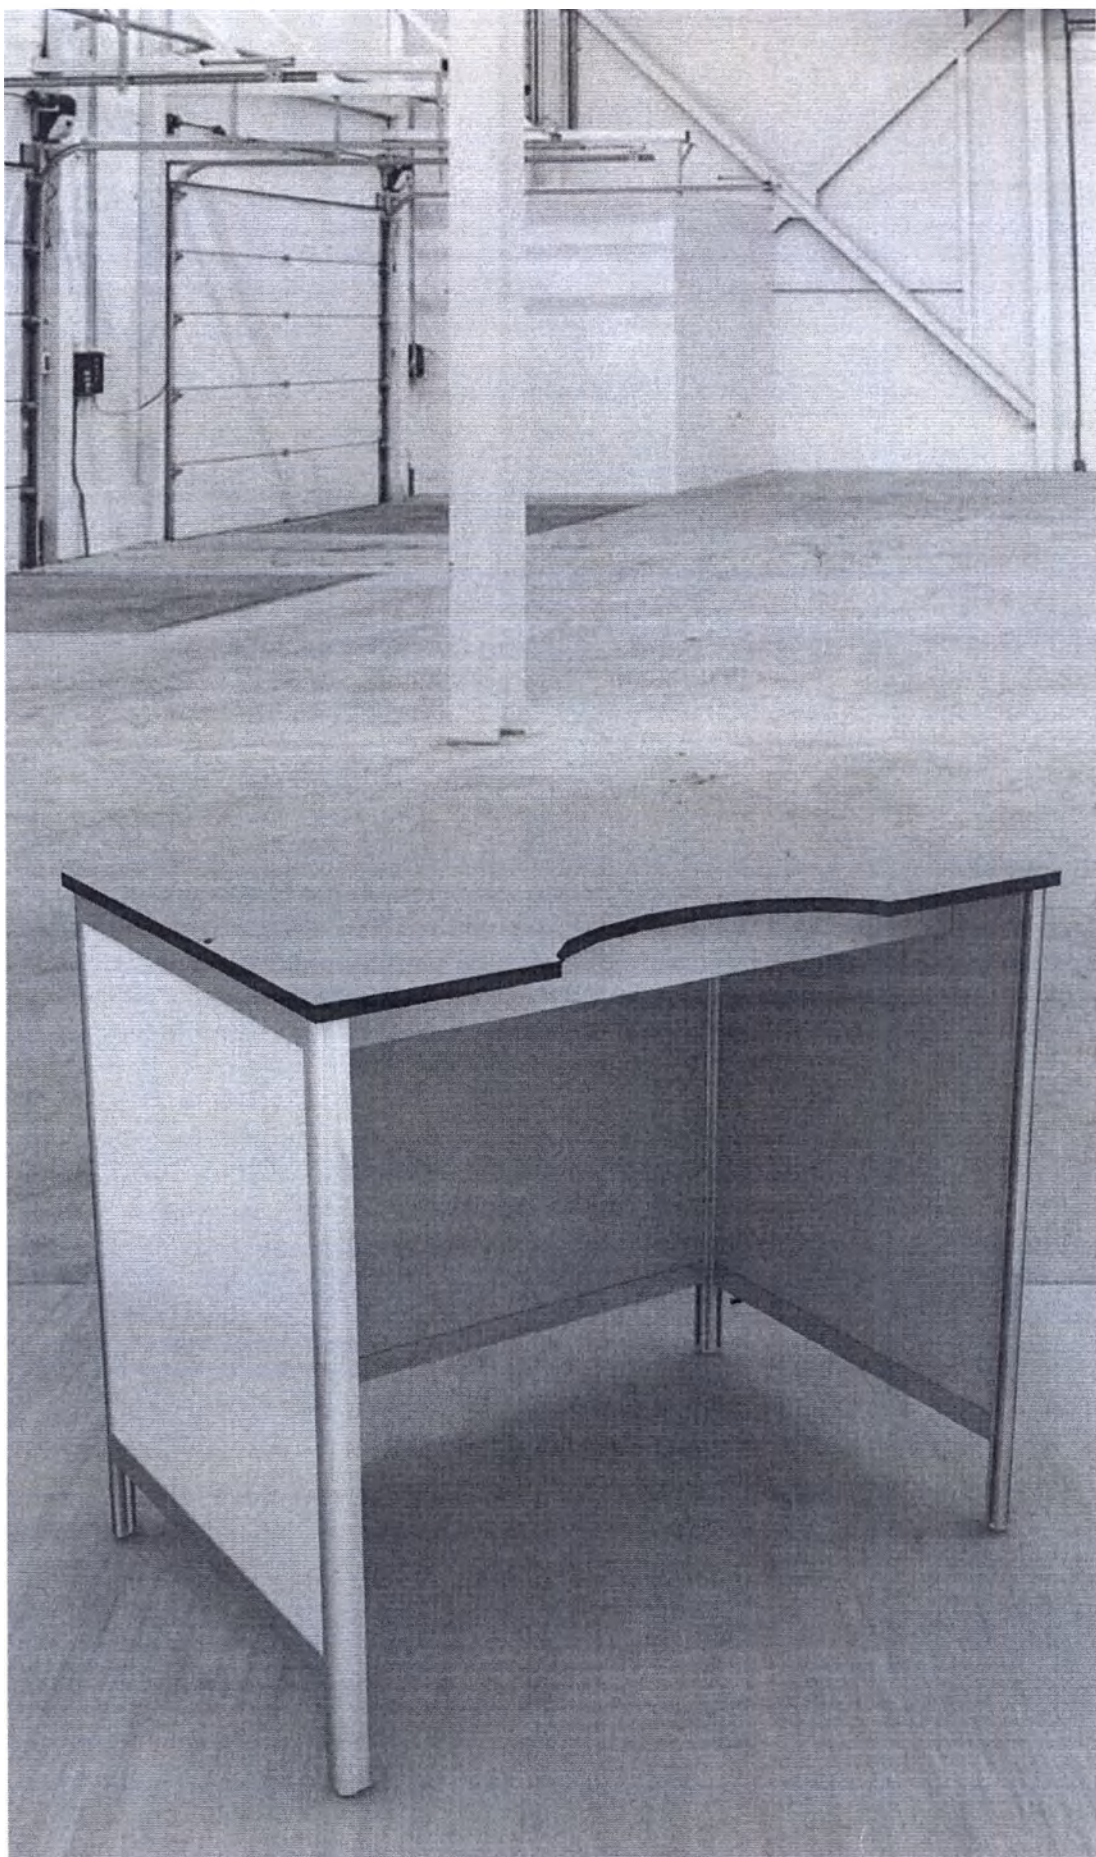

Стол медицинский однотумбовый открытый с выдвижным ящиком (Арт. СЛ-019)

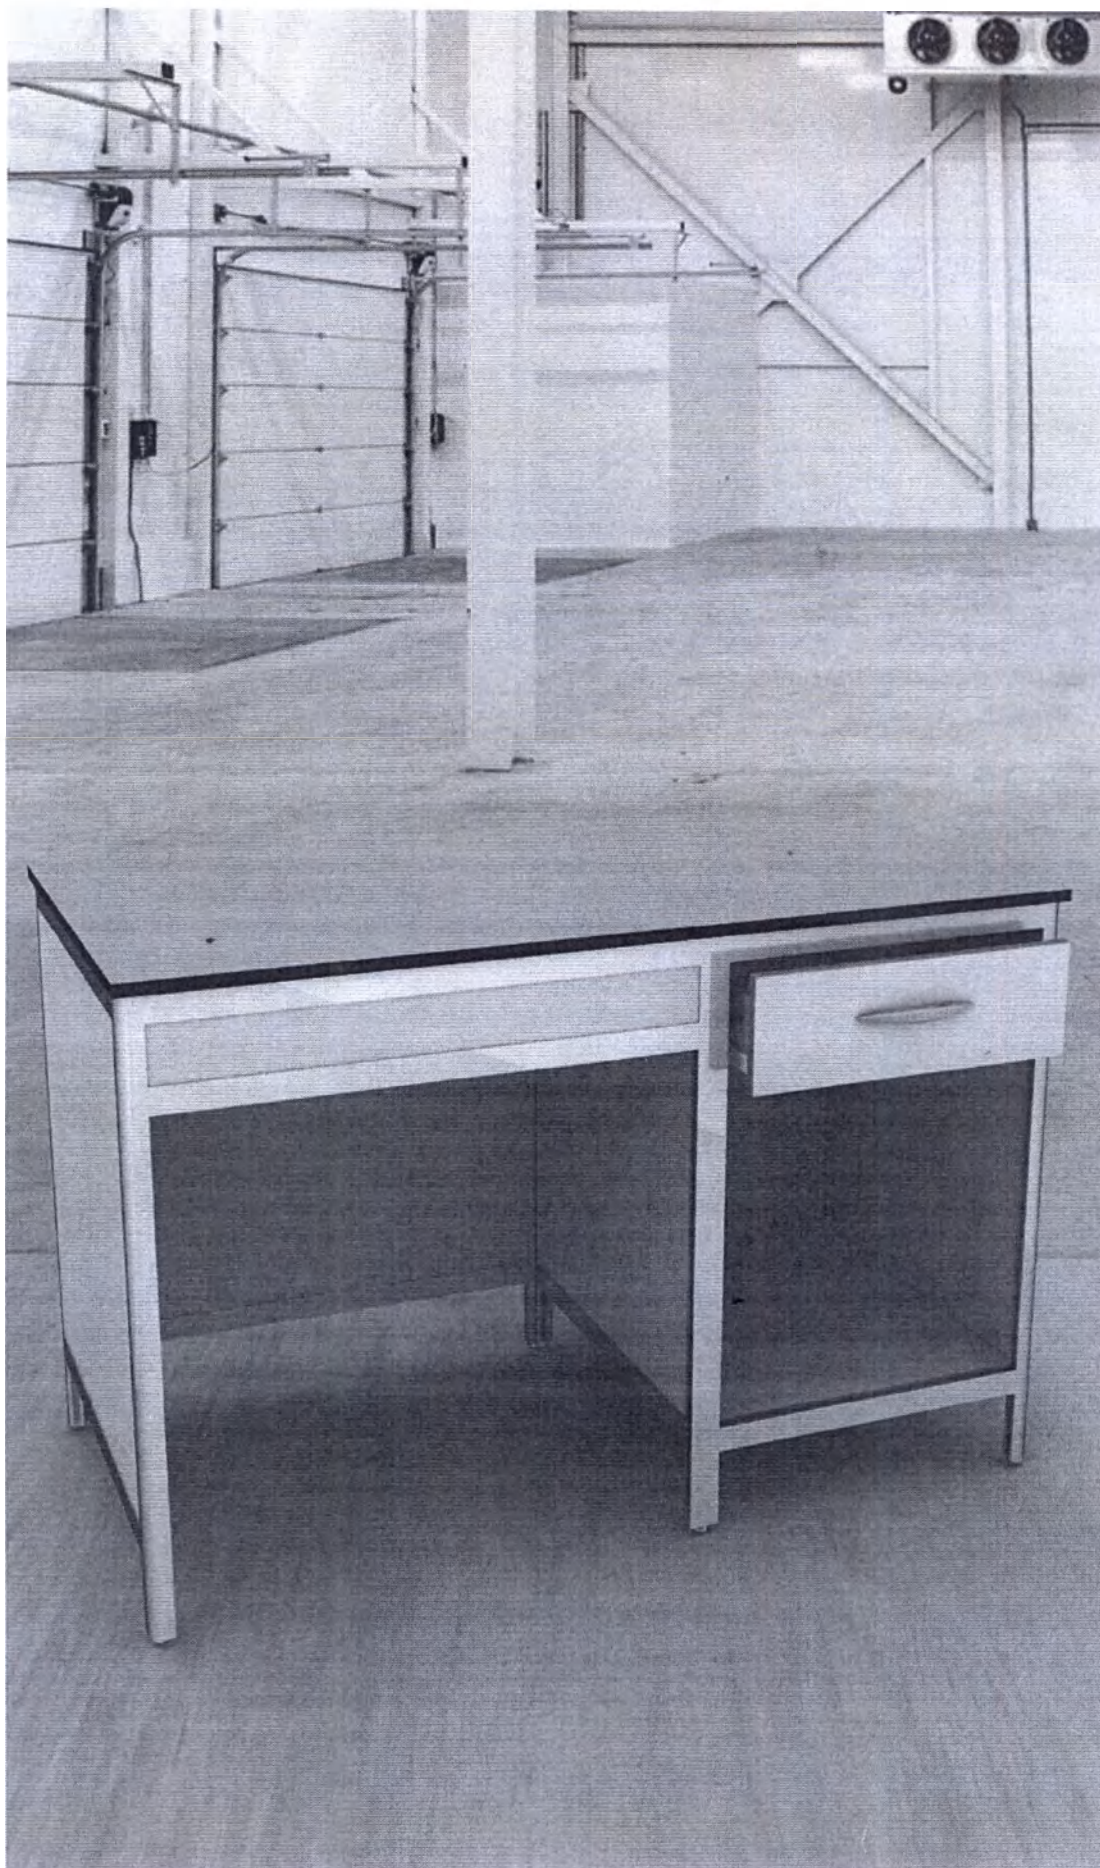


Стол медицинский одностумбовый с тремя выдвижными ящиками (Арт. СЛ-020)



Стол медицинский двухтумбовый с восьмью выдвижными ящиками (Арт. СЛ-021)



Стол медицинский весовой (Арт. СВ-001)

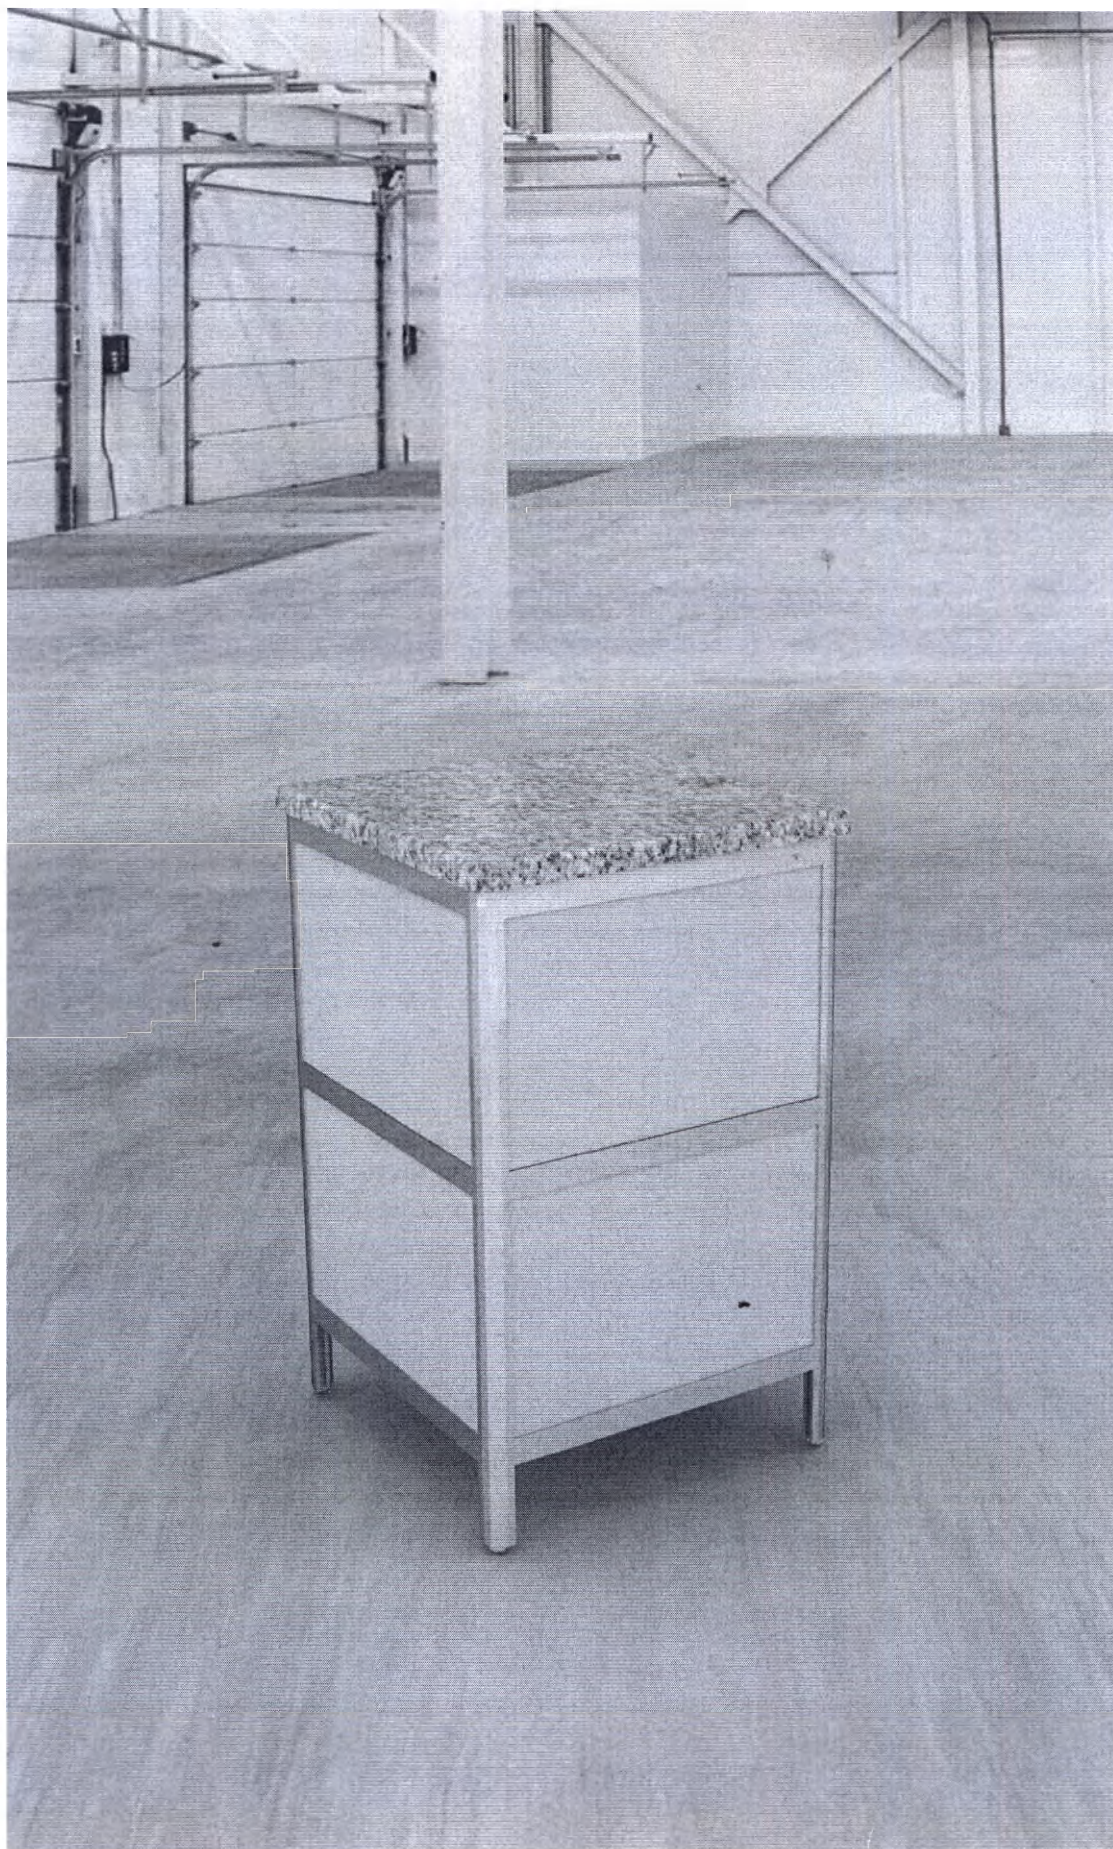

Стол медицинский островной на два рабочих места (Арт. СО-001)




Стол медицинский островной на четыре рабочих места (Арт. СО-002)




Стол медицинский островной на два рабочих места с двумя мойками (Арт. СО-003)



Стол медицинский с надстройкой (Арт. СО-004)

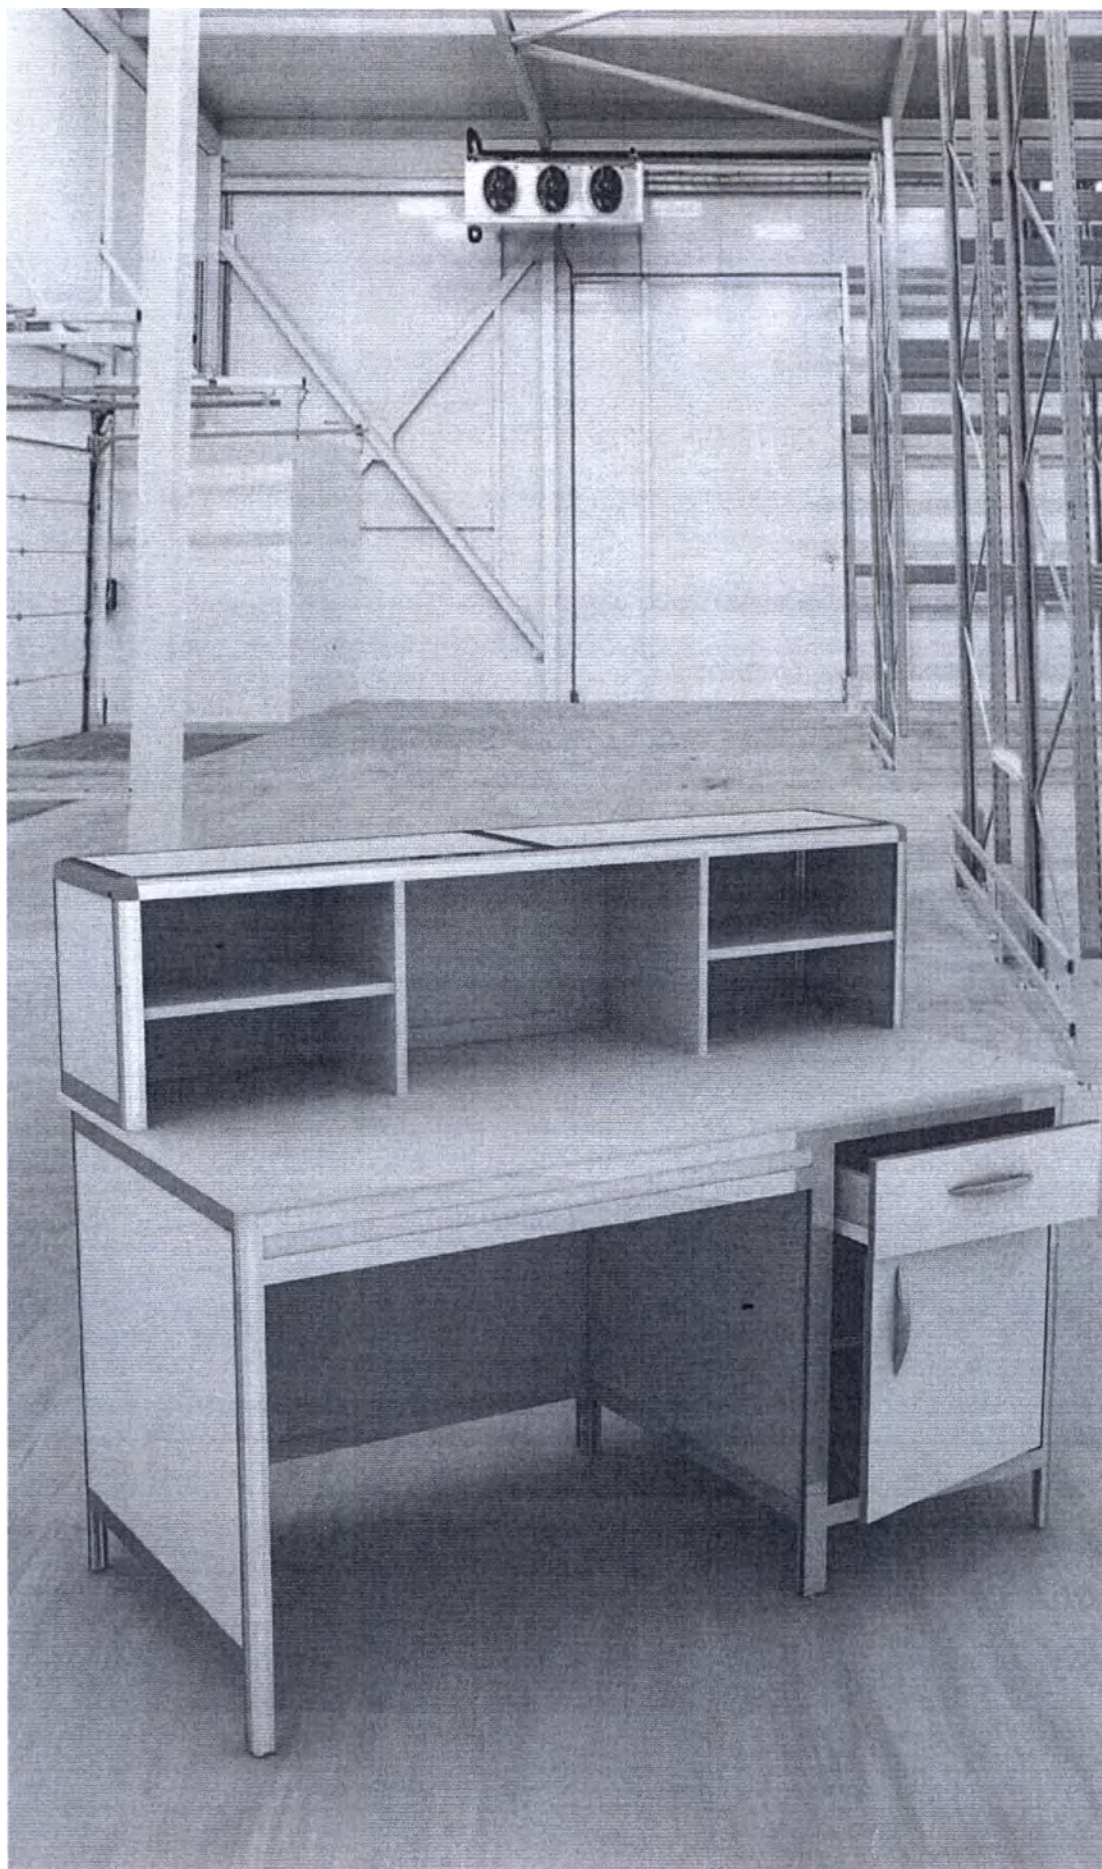

Стол медицинский с двумя дверями (Арт. ШМП-001)

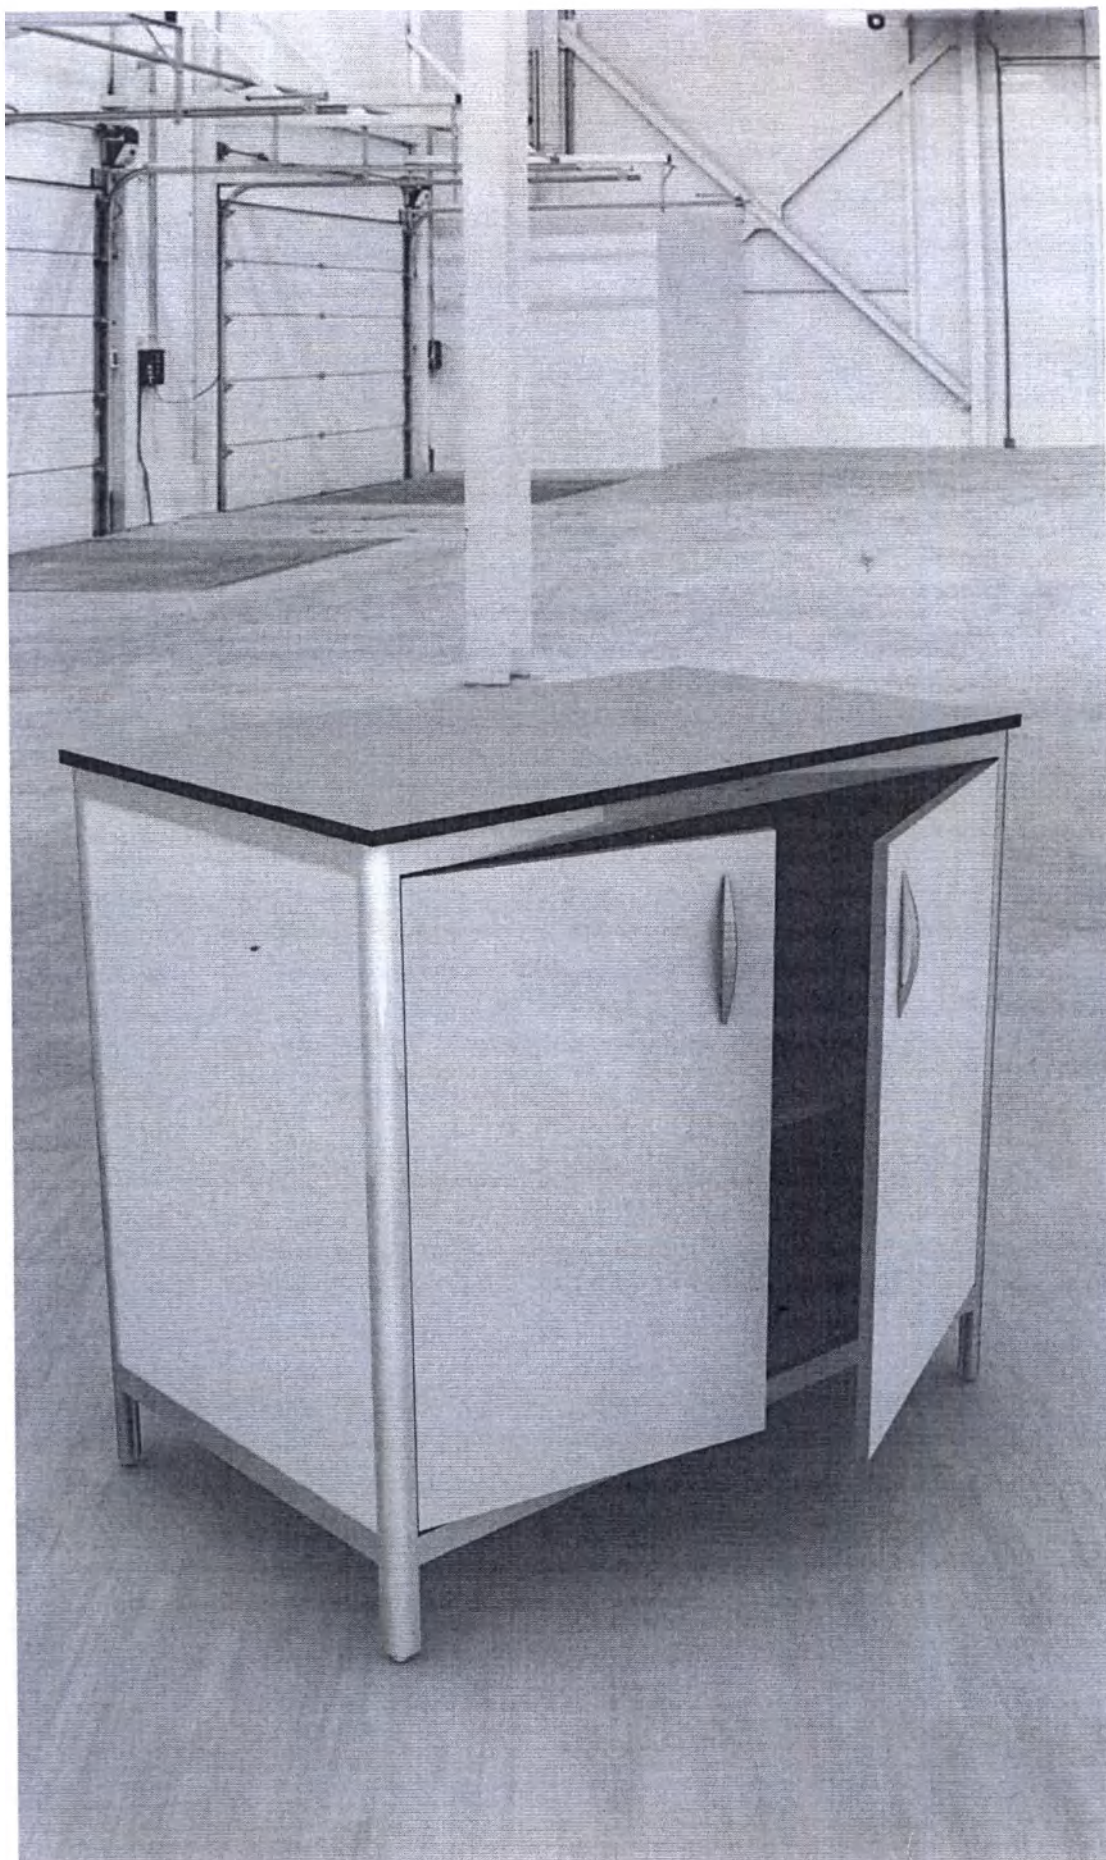


Стол медицинский с четырьмя выдвижными ящиками двухсекционный
(Арт. ШМП-002)




Стол медицинский с четырьмя выдвижными ящиками и двумя дверями двухсекционный
(Арт. ШМП-003)



Стол медицинский с тремя дверями двухсекционный (Арт. ШМП-004)

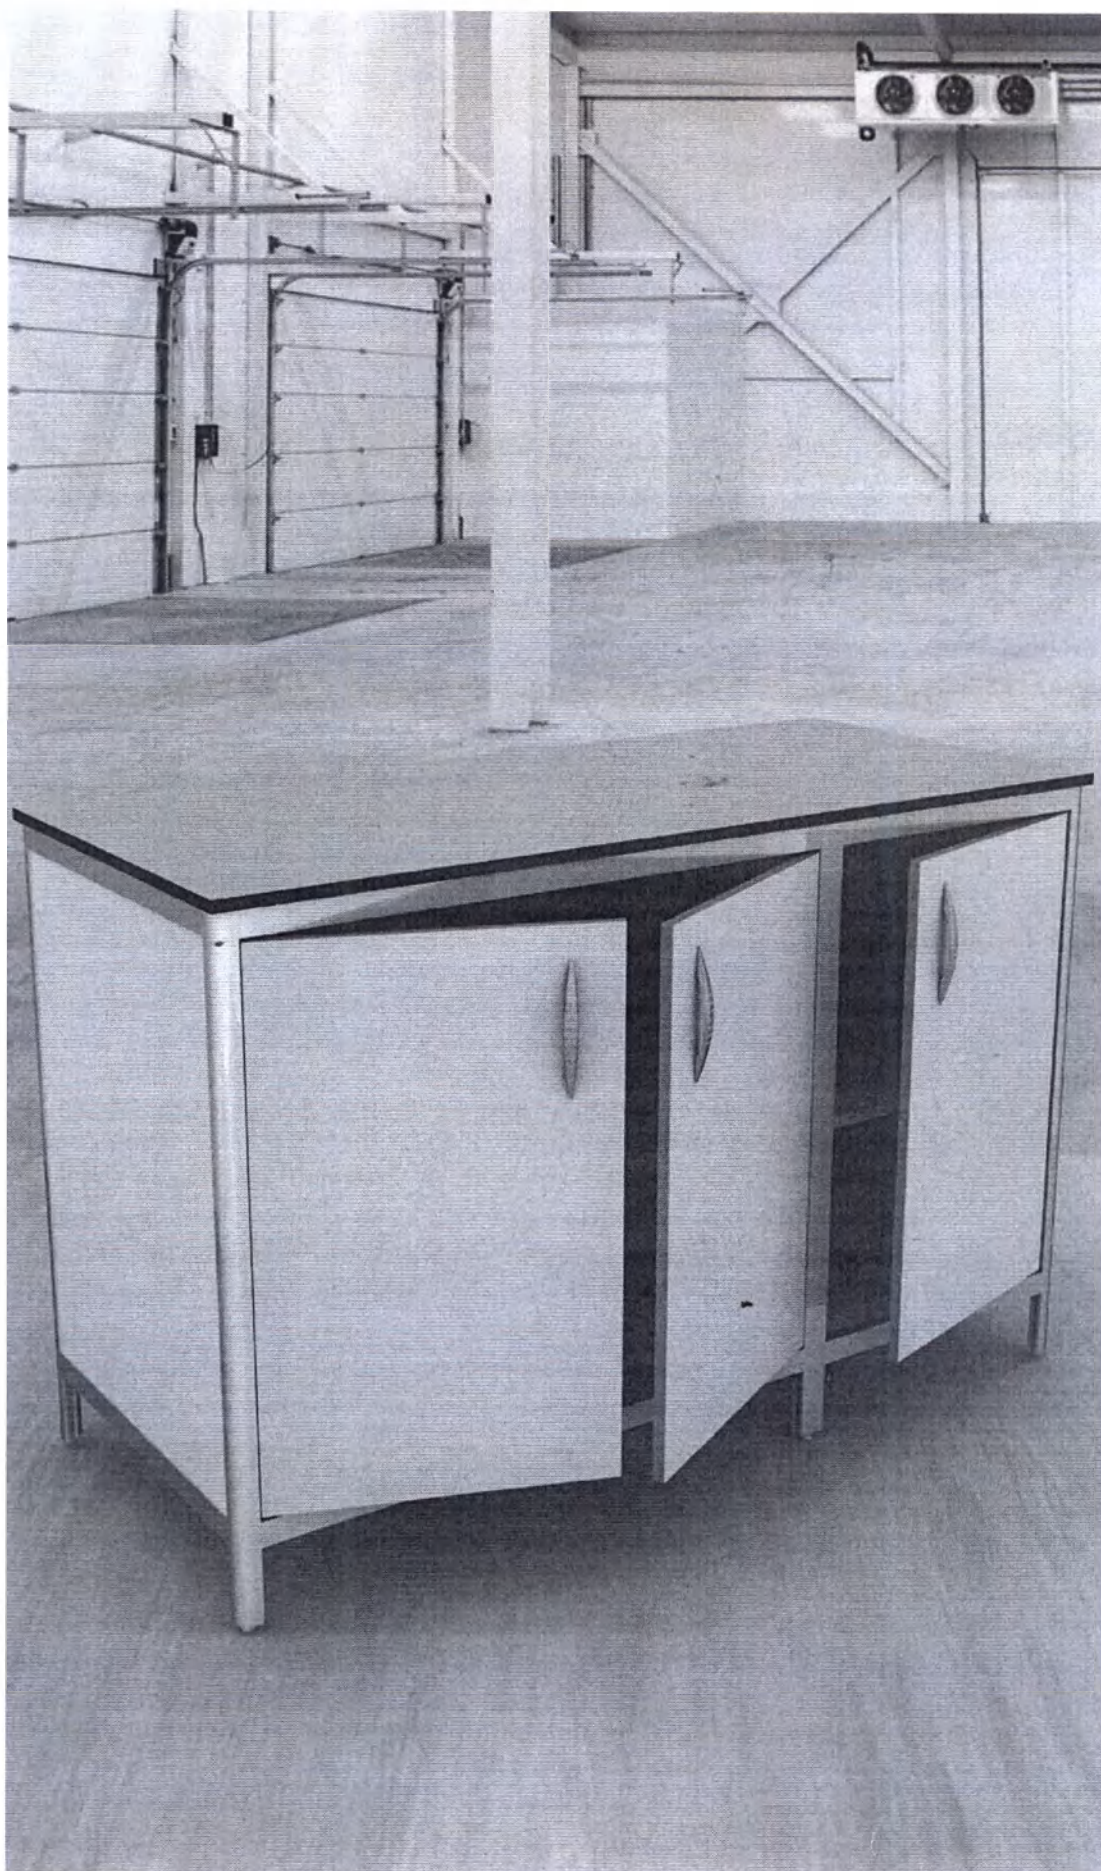

Стол медицинский угловой с двумя дверями (Арт. ШМП-005)

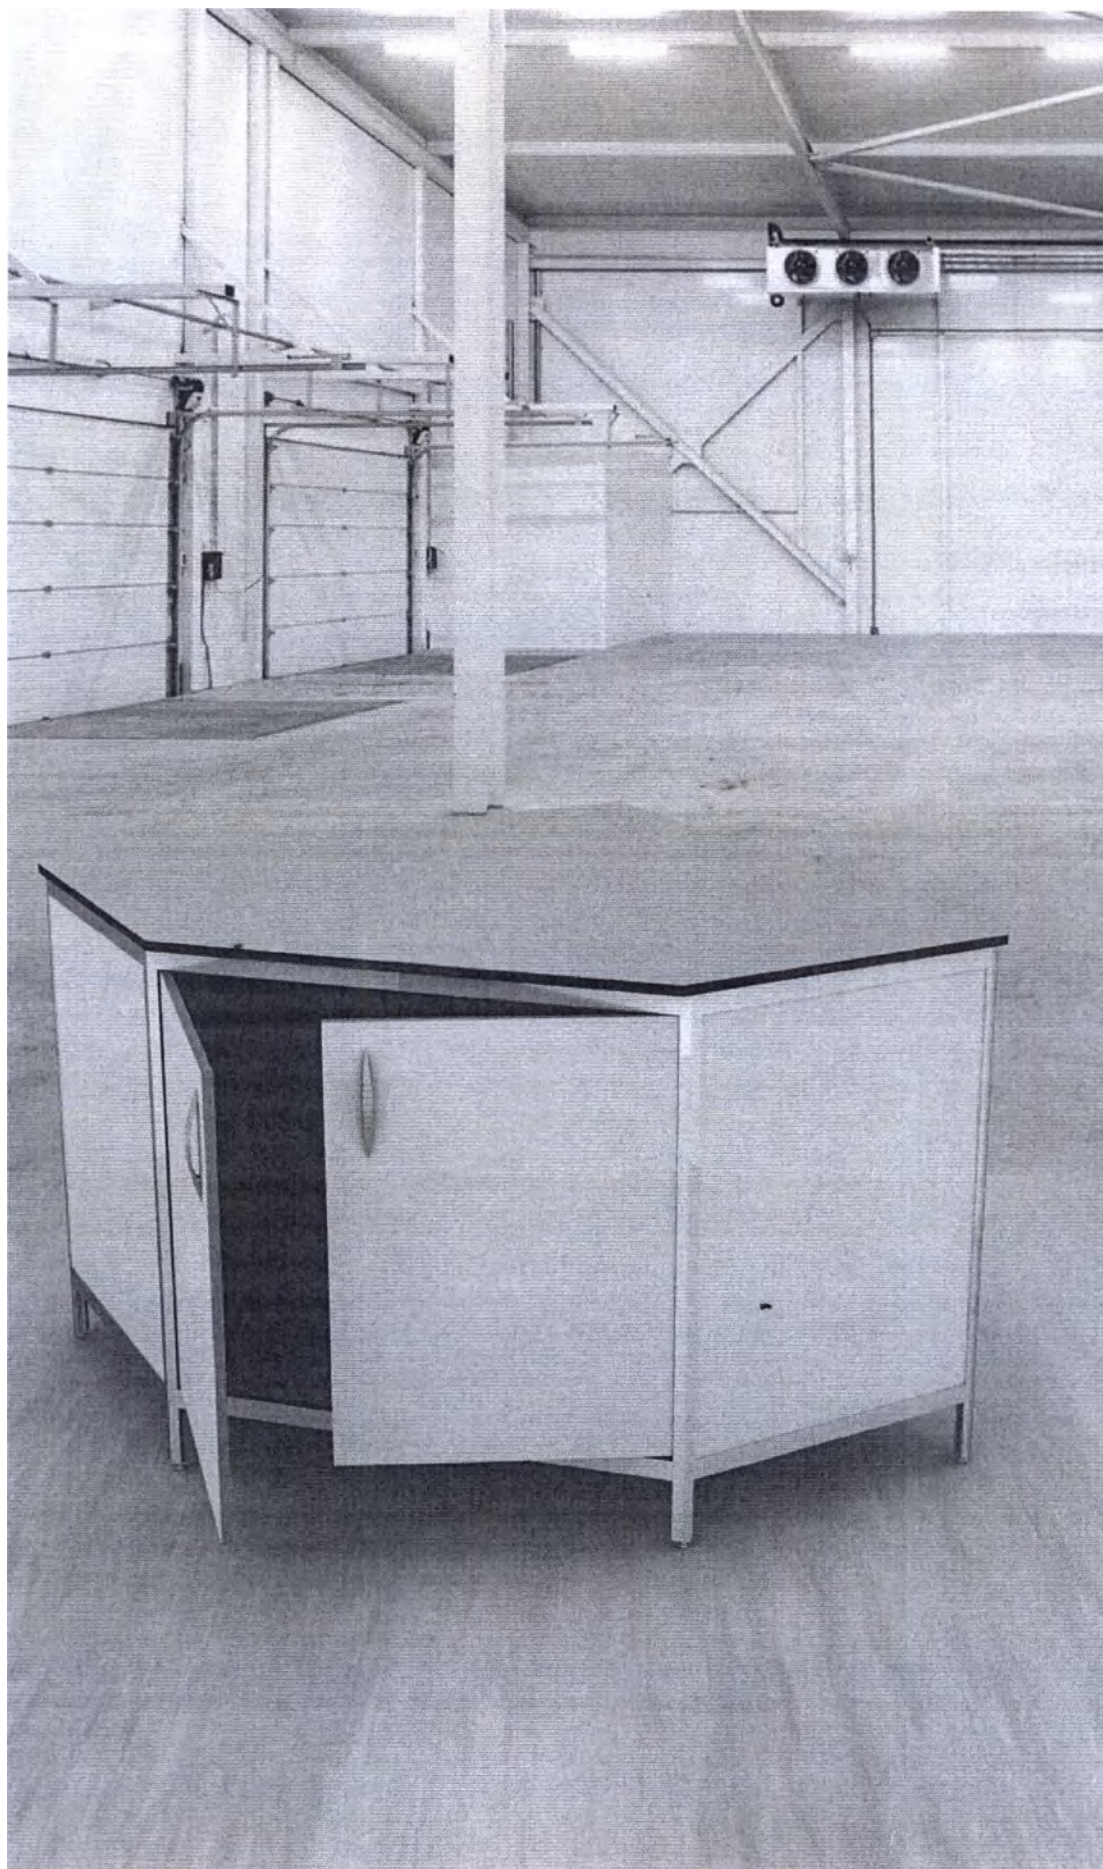

Стол медицинский под мойку с дверцей (Арт. ШМП(М)-006)




Стол медицинский под мойку двухстворчатый (Арт. ШМП(М)-007)



Стол медицинский под двойную мойку (Арт. ШМП(М)-008)





Стол медицинский под мойку с тремя дверями (Арт. ШМП(М)-009)

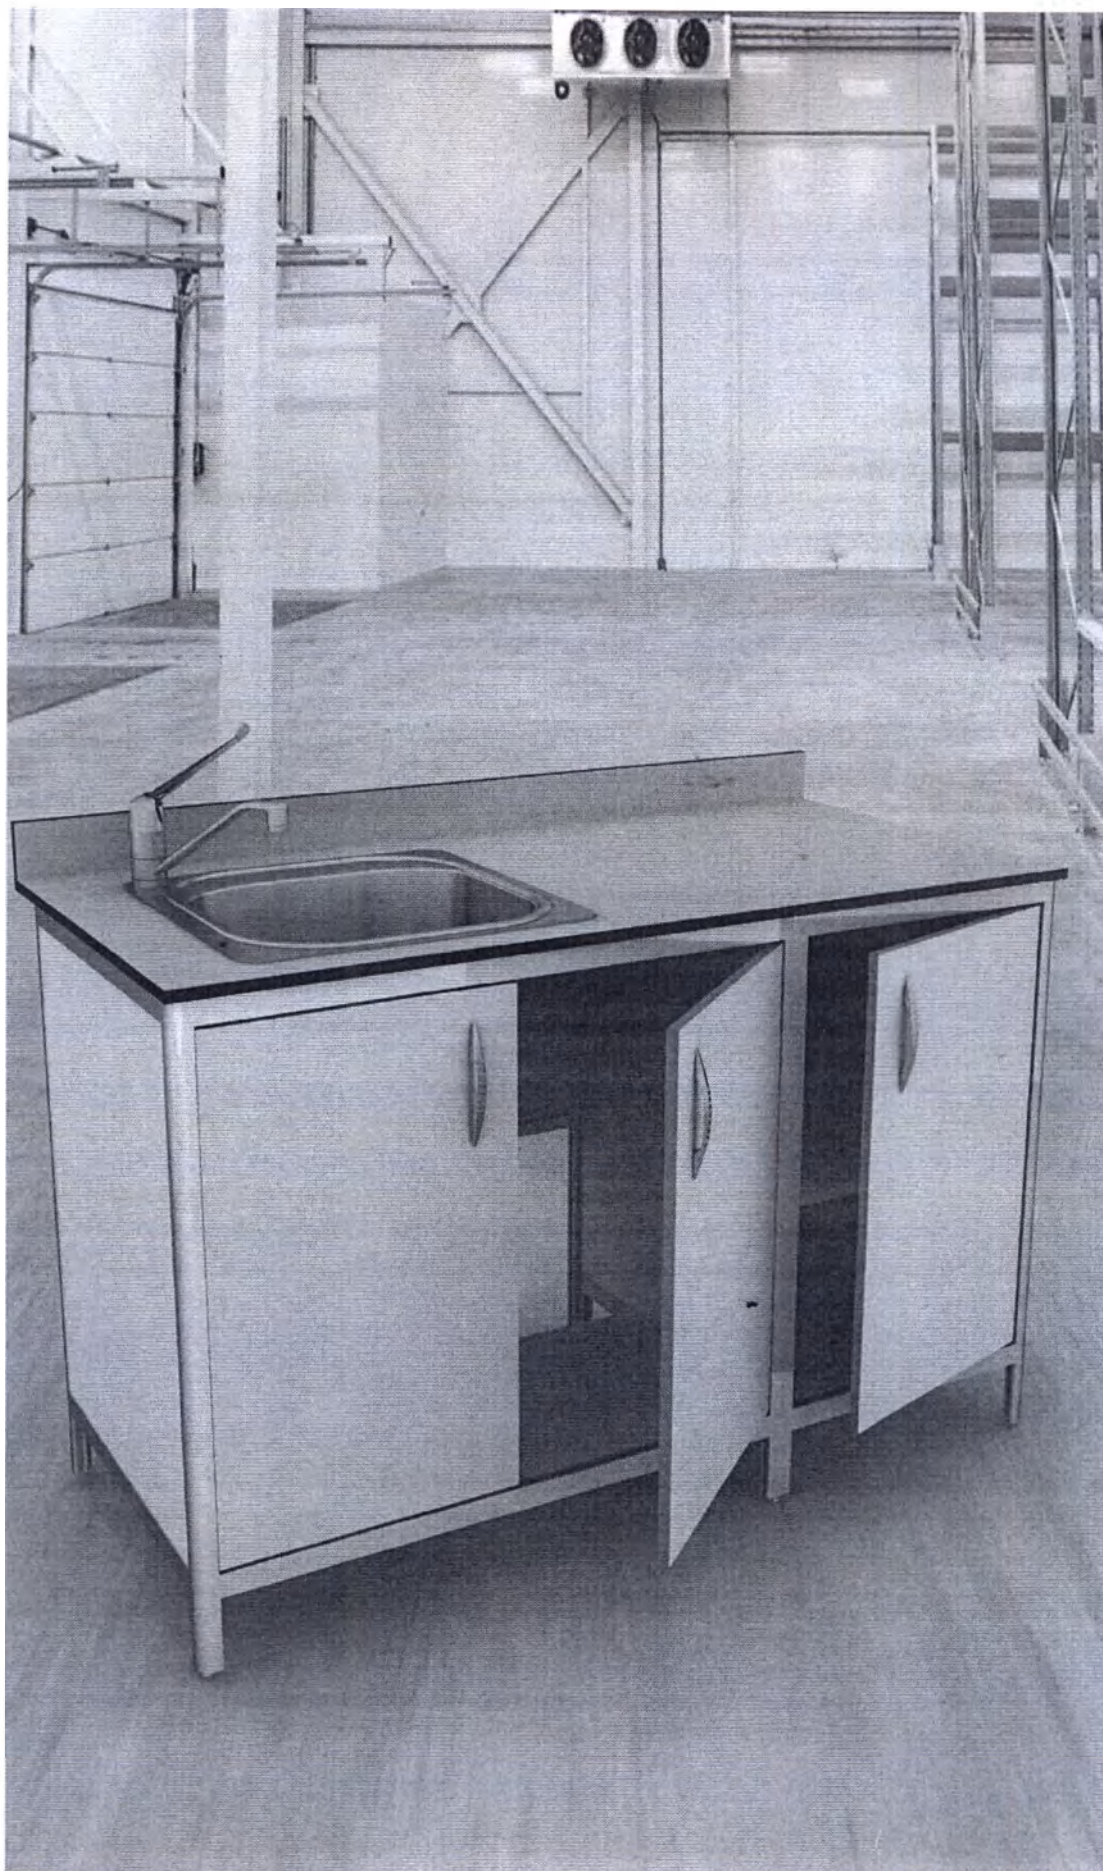


Стол медицинский под мойку с четырьмя ящиками двухсекционный
(Арт. ШМП(М)-010)



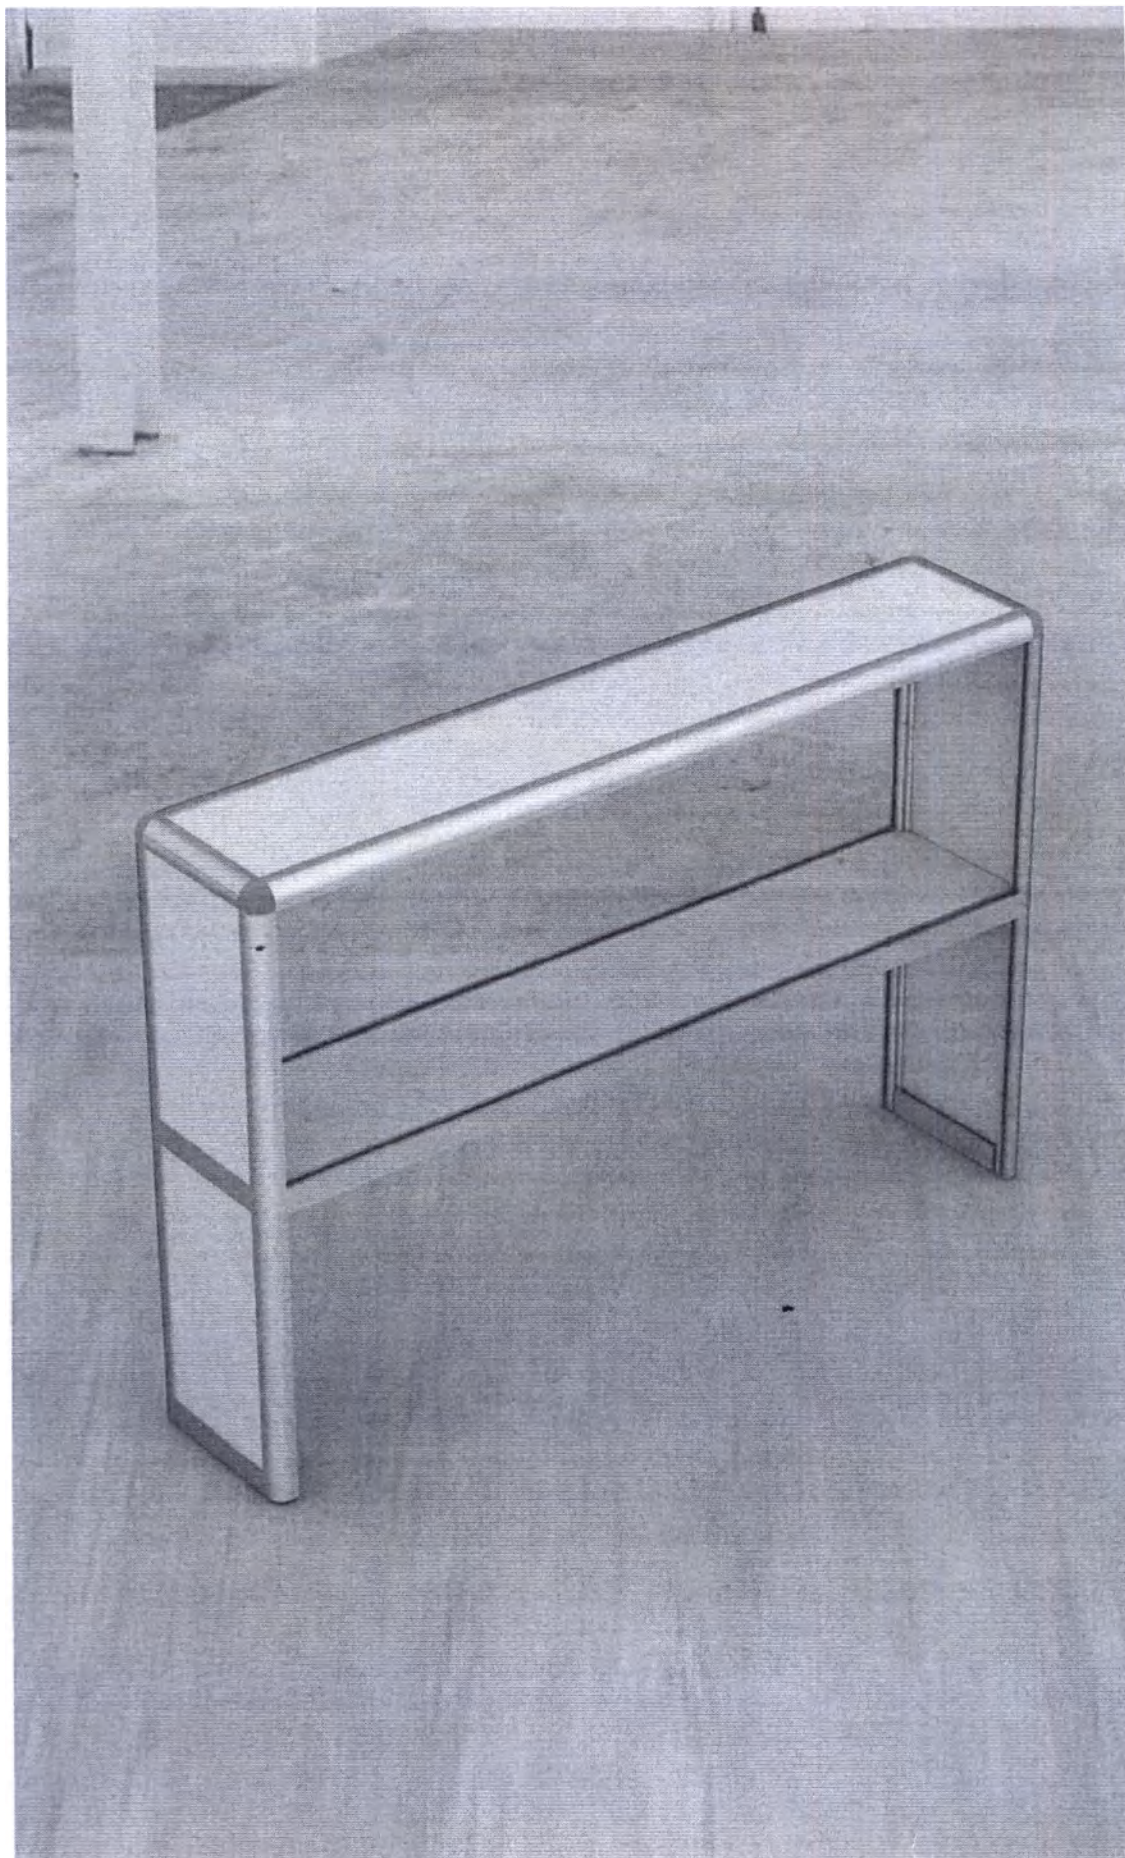

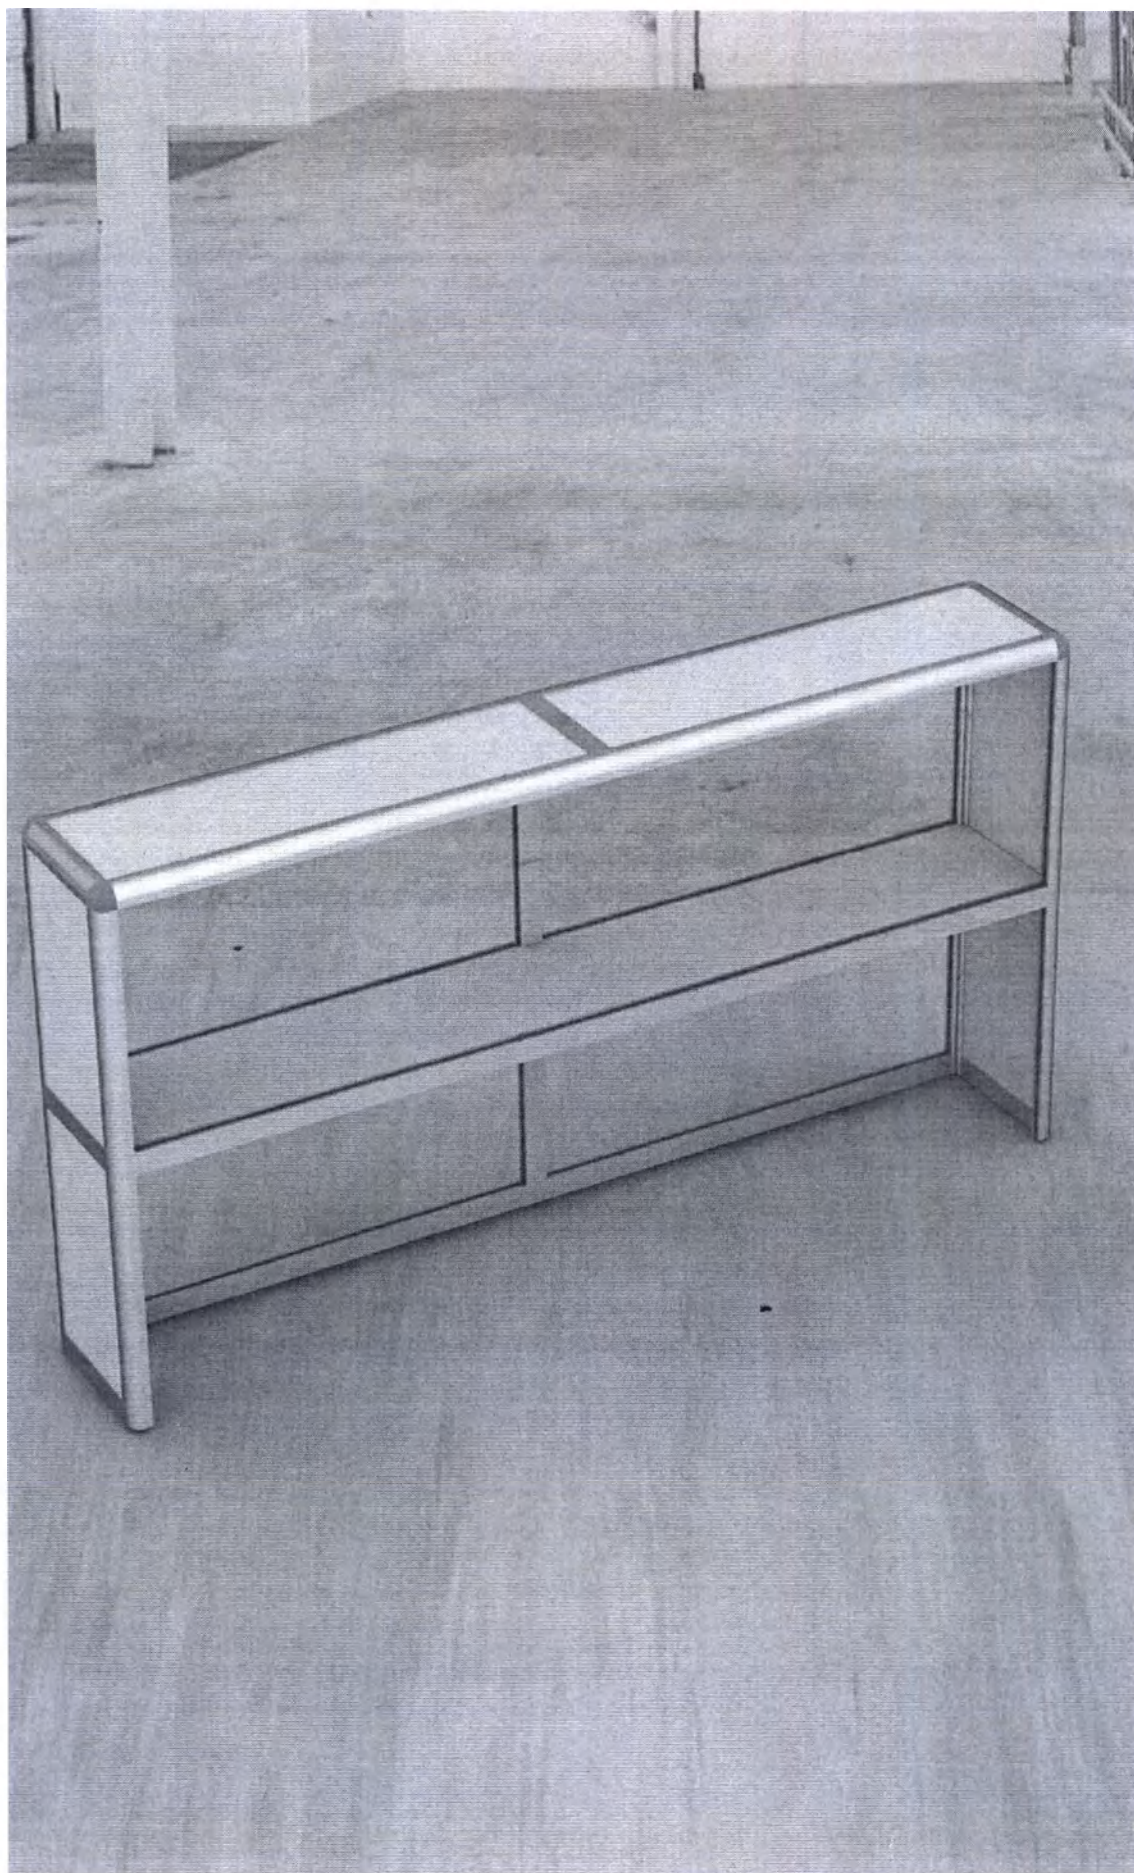

Принадлежности. Полка медицинская настольная двухсекционная с двумя дверями
(Арт. ПН(Д)-003)

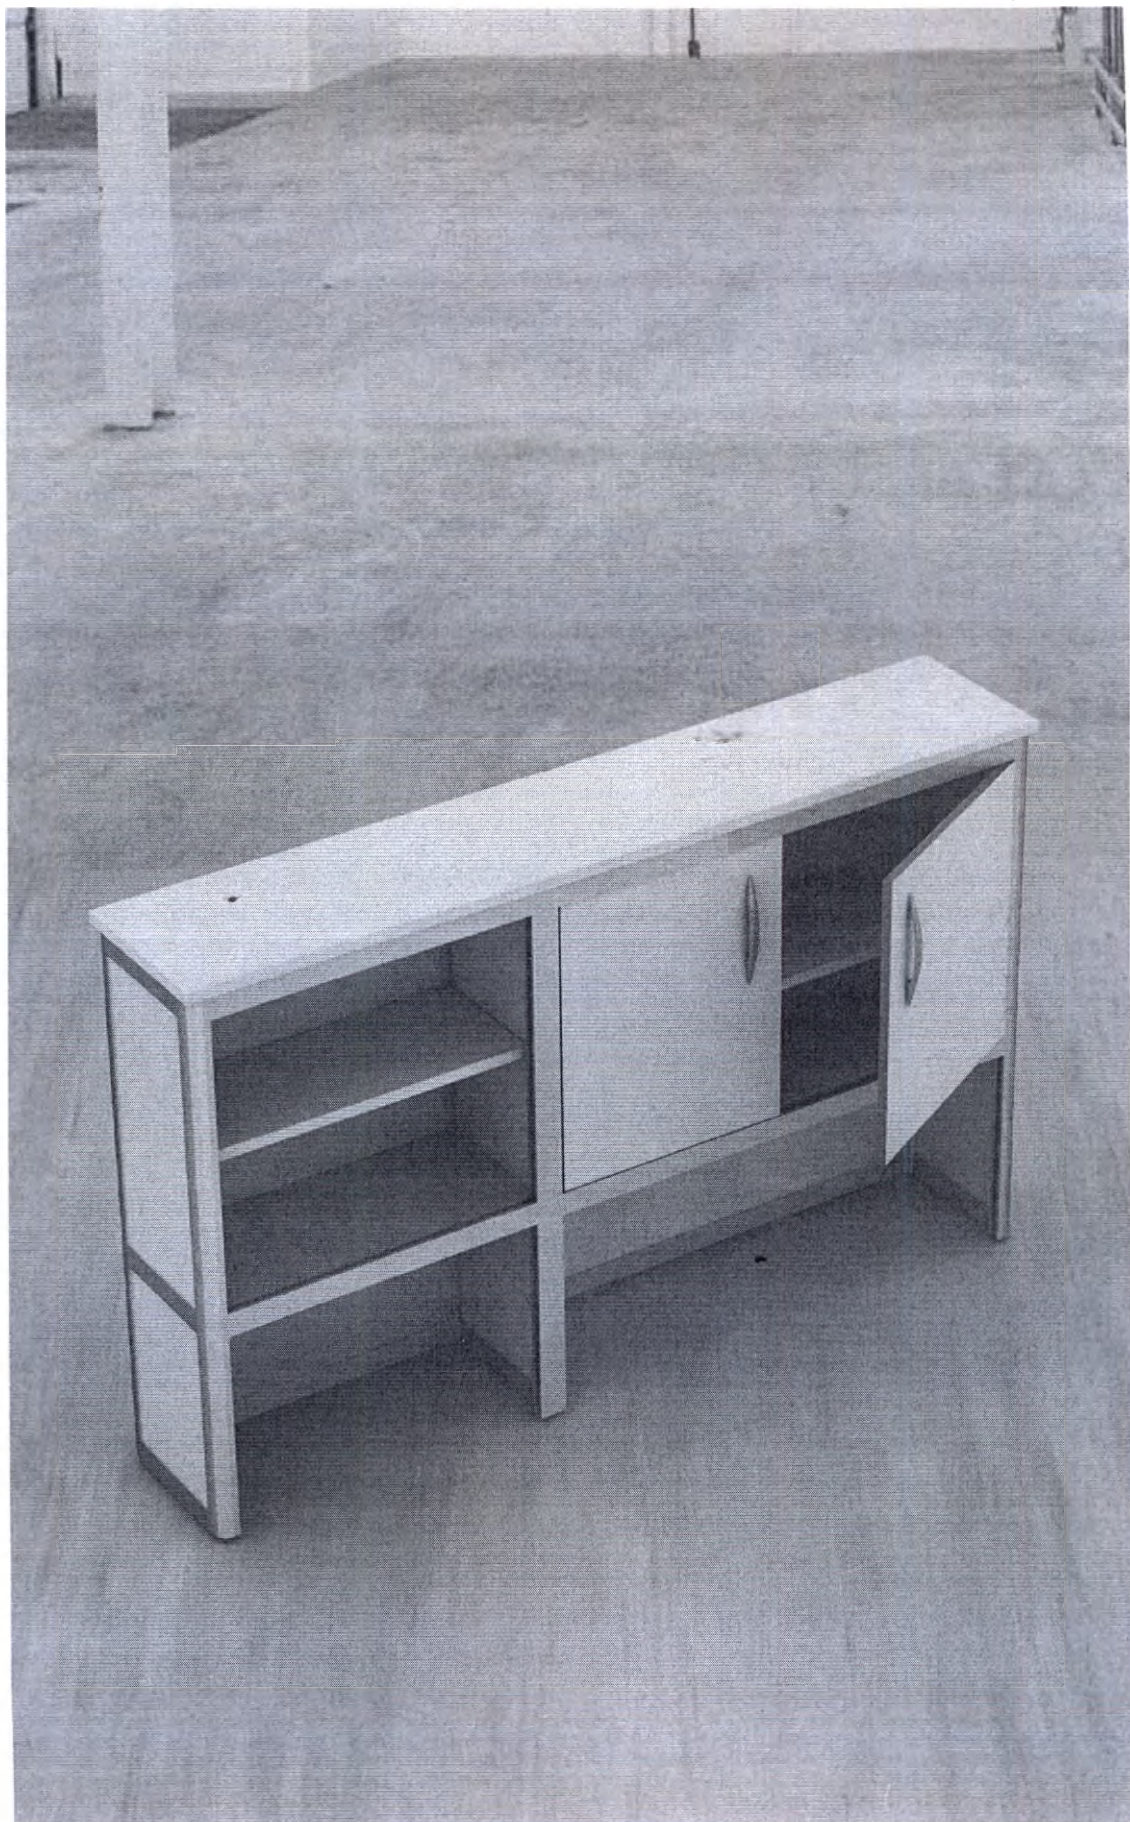



ООО «ВИТА»	
 Юридический адрес: 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206	ГОСТ 16371-2014 ТУ 32.50.30-003-48837523-2019 Изготовлено в Российской Федерации
Наименование изделия по эксплуатационному и функциональному назначению, обозначение изделия (артикул) по ТУ 32.50.30-003-48837523-2019 Вариант:	
Дата изготовления:  .20	Порядок применения, гарантия изготовителя: см. Инструкцию по применению ПТИС.324159.001 И
Заводской номер:  XXXXXX	
Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца	
Срок службы: 4 года	
Транспортировать при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 100%. Хранить в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.	


Шаблон маркировки изделия

Наименование изделия по ТУ 32.50.30-003-48837523-2019	
Вариант:	
Масса нетто:	РУ № РЗН
Масса брутто:	
Габаритные размеры: ШхГхВ	
 ООО «ВИТА» 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206   	

Шаблон транспортной маркировки

ООО «ВИТА»	
 Юридический адрес: 690105, Приморский край, город Владивосток, Бородинская улица, дом 46/50, офис 206	ГОСТ 16371-2014 ТУ 32.50.30-003-48837523-2019 Изготовлено в Российской Федерации
Стол медицинский по ТУ 32.50.30-003-48837523-2019 Вариант: Стол медицинский с перегородкой (Арт. СЛ-006)	
Дата изготовления:  12.2019	Порядок применения, гарантия изготовителя: см. Инструкцию по применению ПТИС.324159.001 И
Заводской номер:  004679	
Гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца	
Срок службы: 4 года	
Транспортировать при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 100%. Хранить в крытых помещениях при температуре не ниже плюс 2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.	

Пример маркировки Стола медицинского с перегородкой (Арт. СЛ-006)

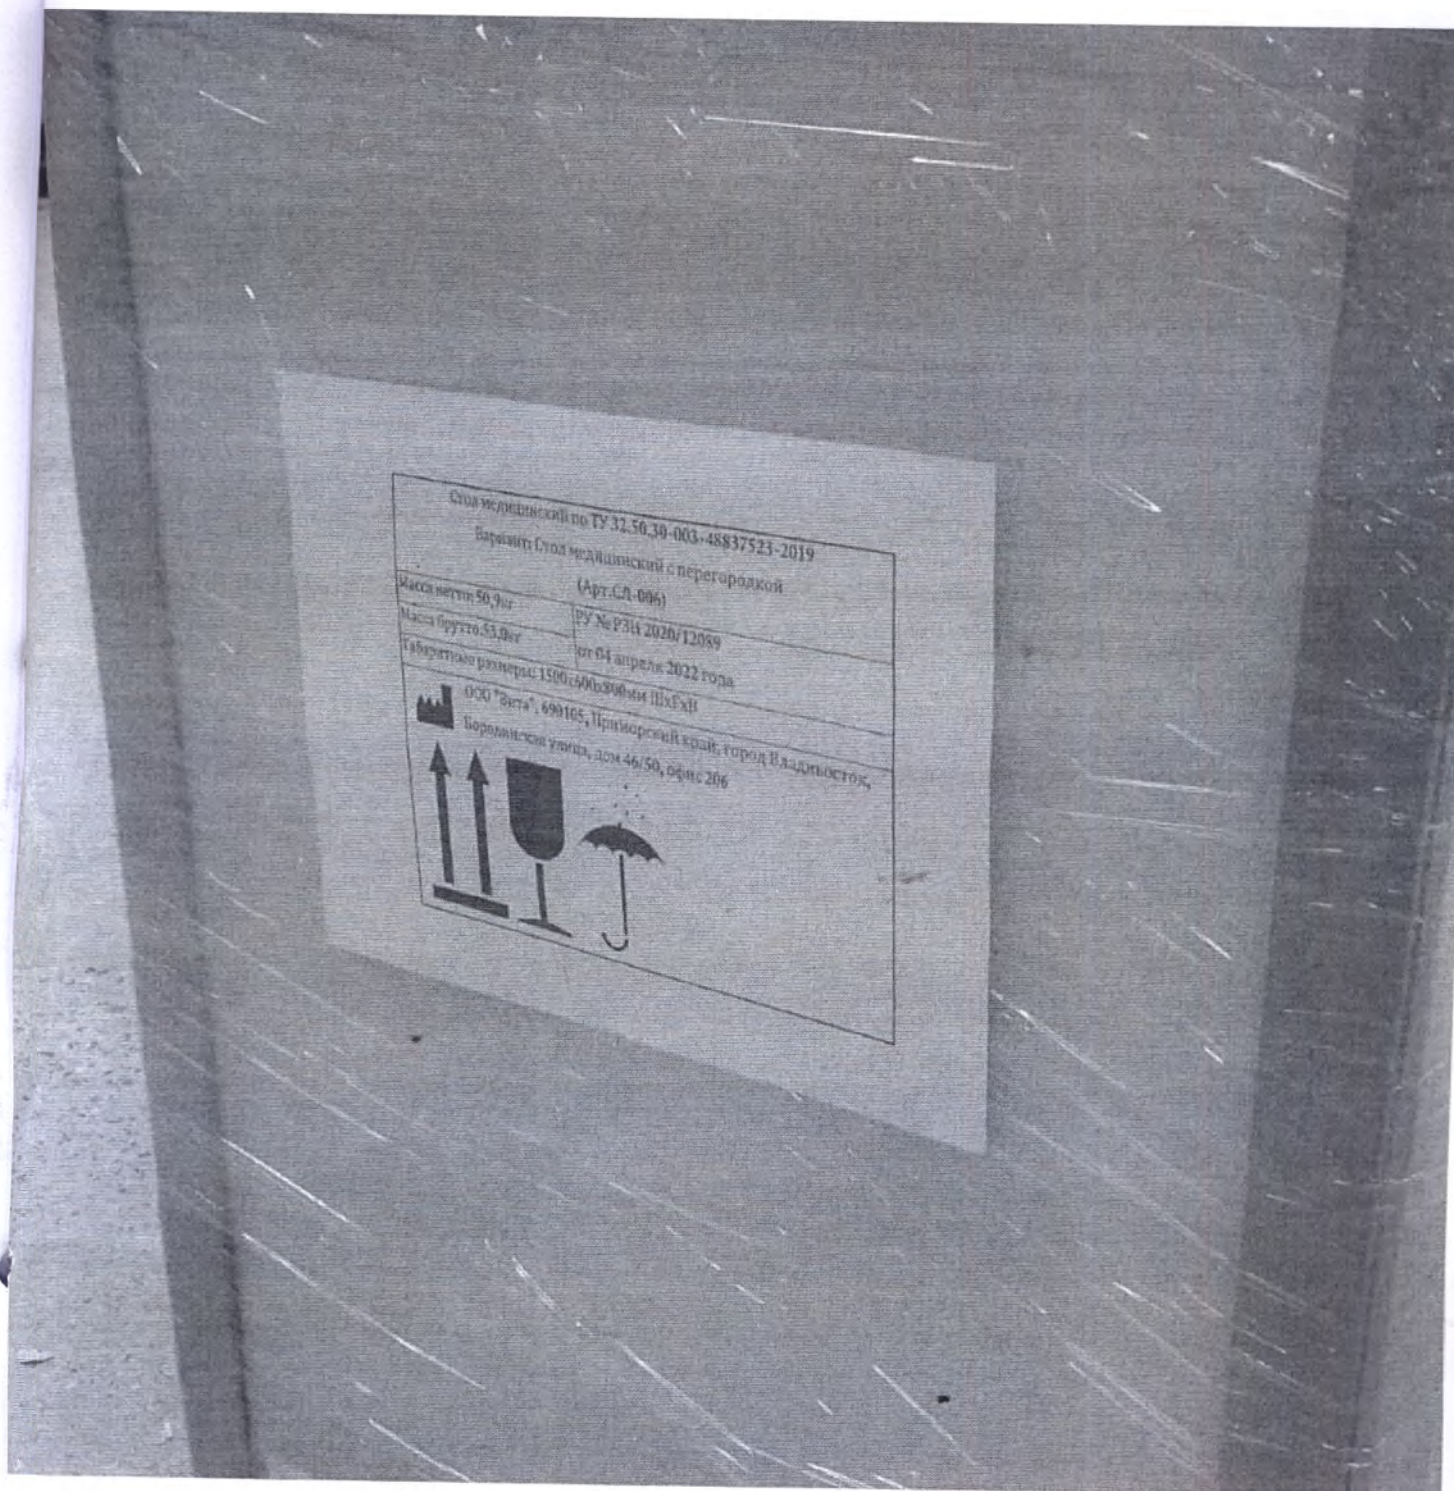

Пример транспортной маркировки Стола медицинского с перегородкой (Арт. СЛ-006)

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 37 лист(ов)

Генеральный директор
ООО «Вита»

Чайс Н.Н.
« 20 » сентября 2020

