



# **ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ медицинского изделия**

**Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями**


I. Анализатор автоматический гематологический (Auto Hematology Analyzer) исполнения: URIT-5380 в составе:

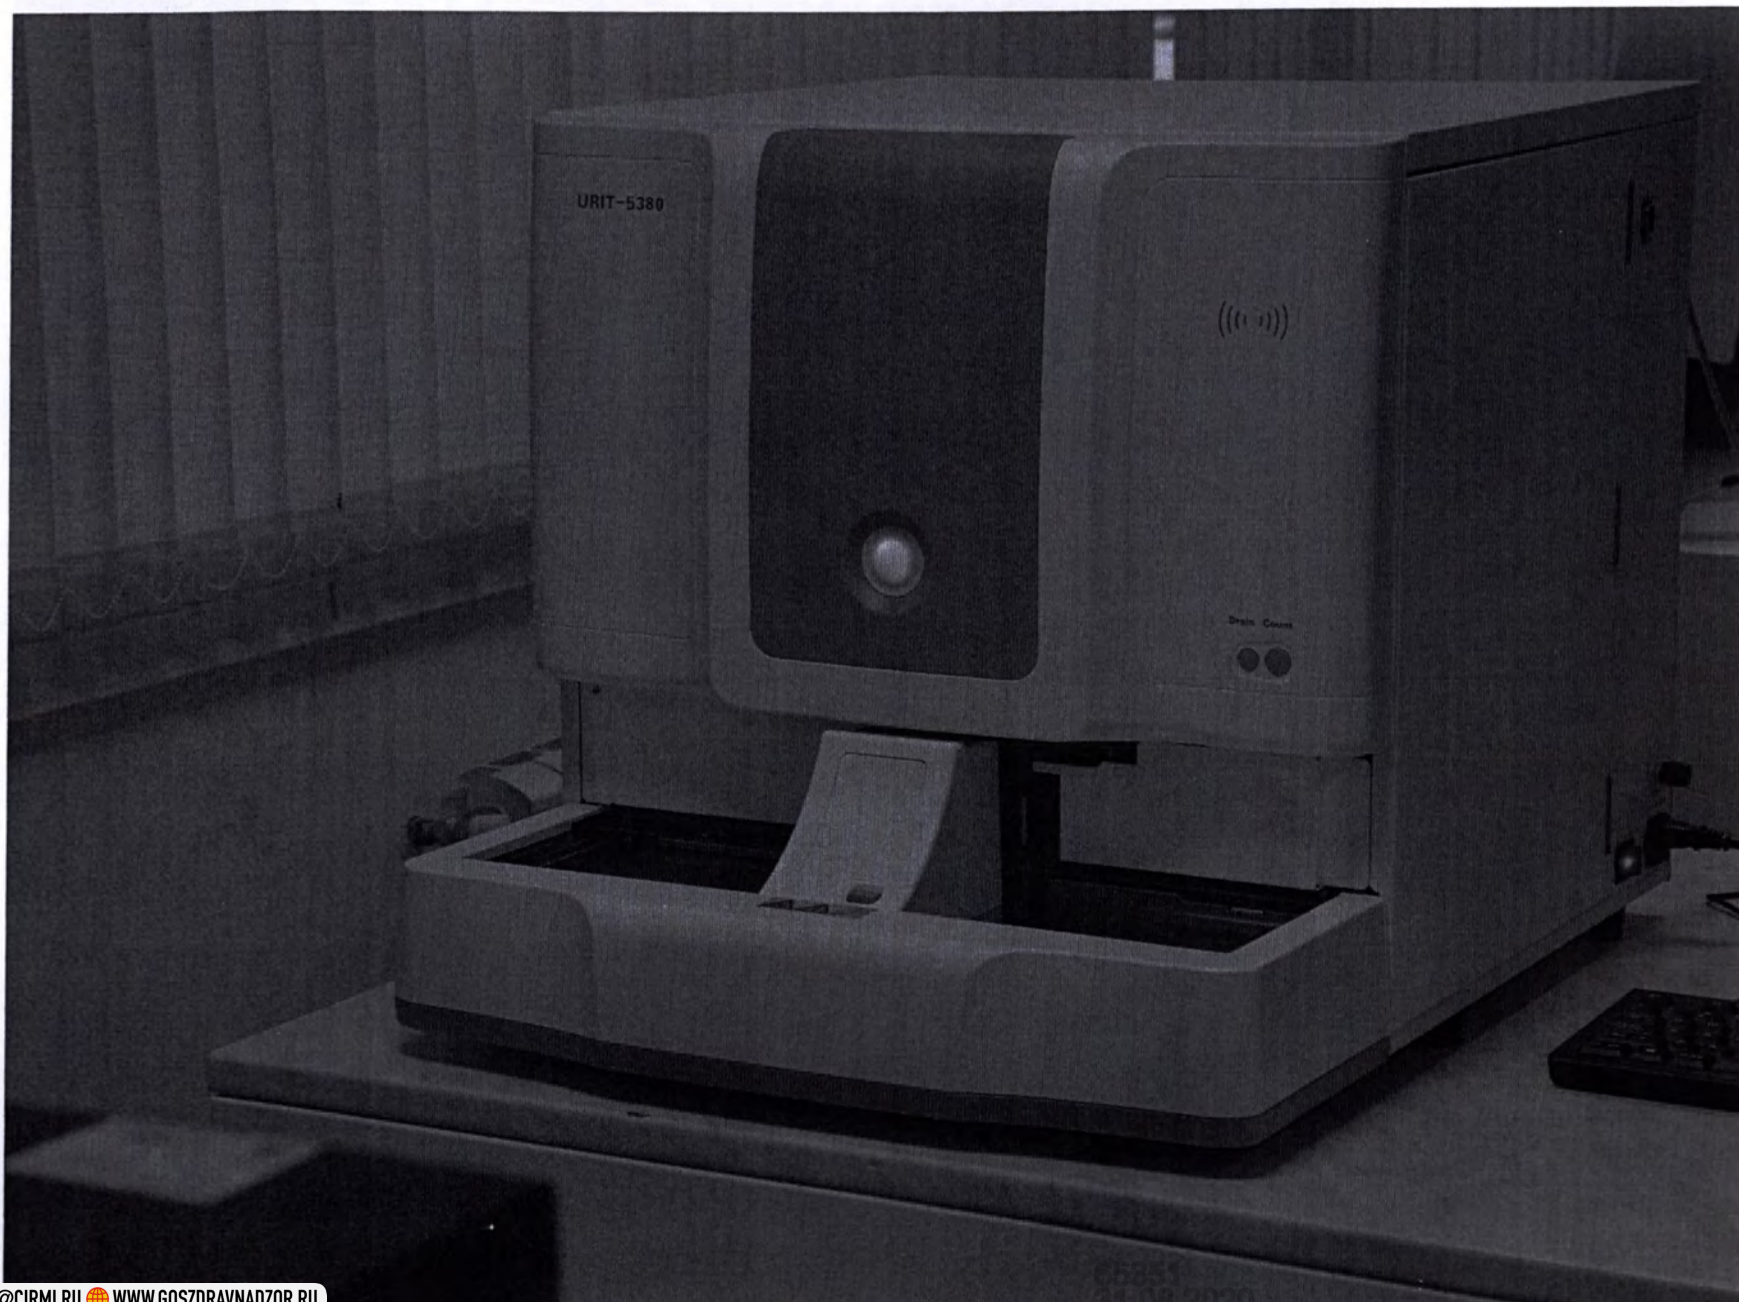

1. Анализатор автоматический гематологический (Auto Hematology Analyzer) исполнения: URIT-5380 в составе:

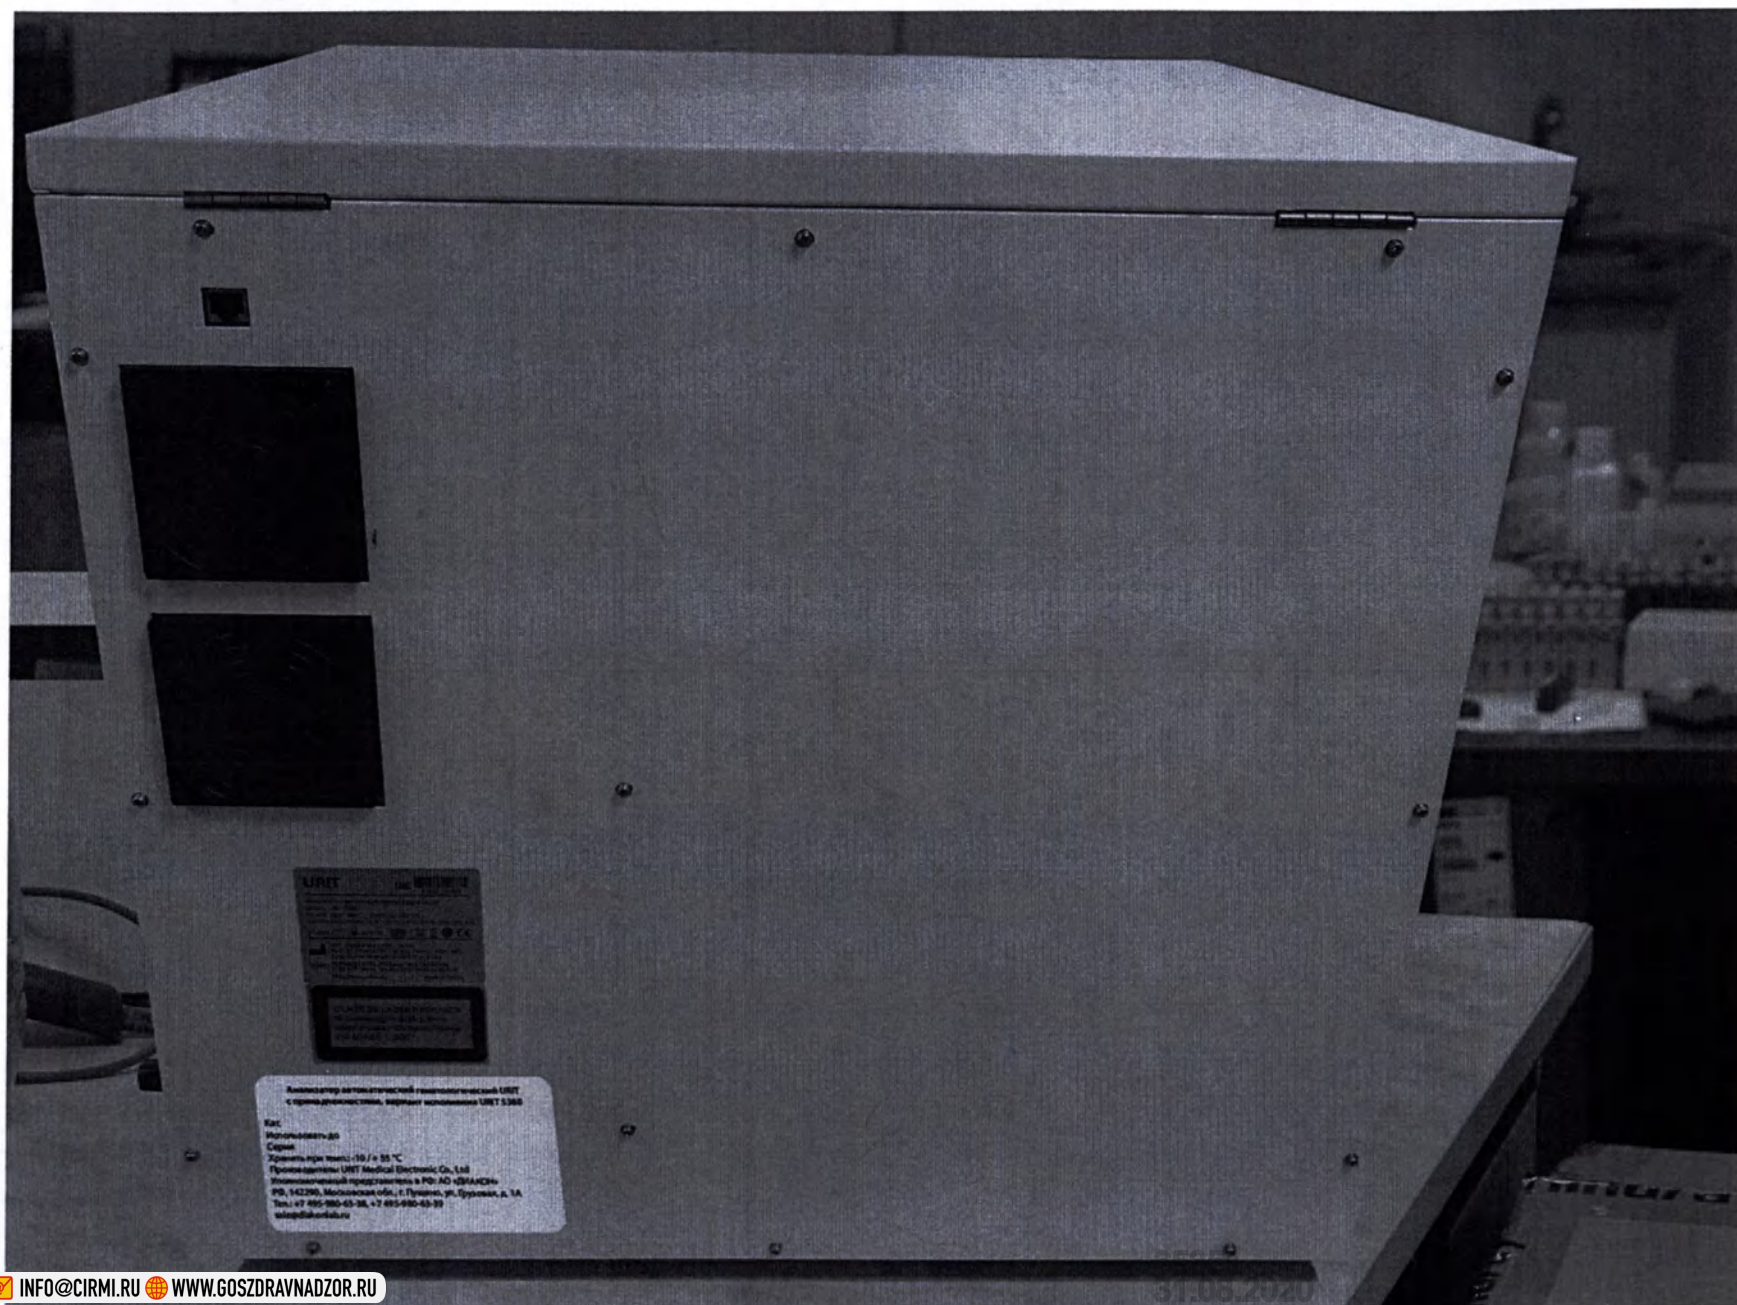


## 2. Руководство пользователя (Operation Manual).

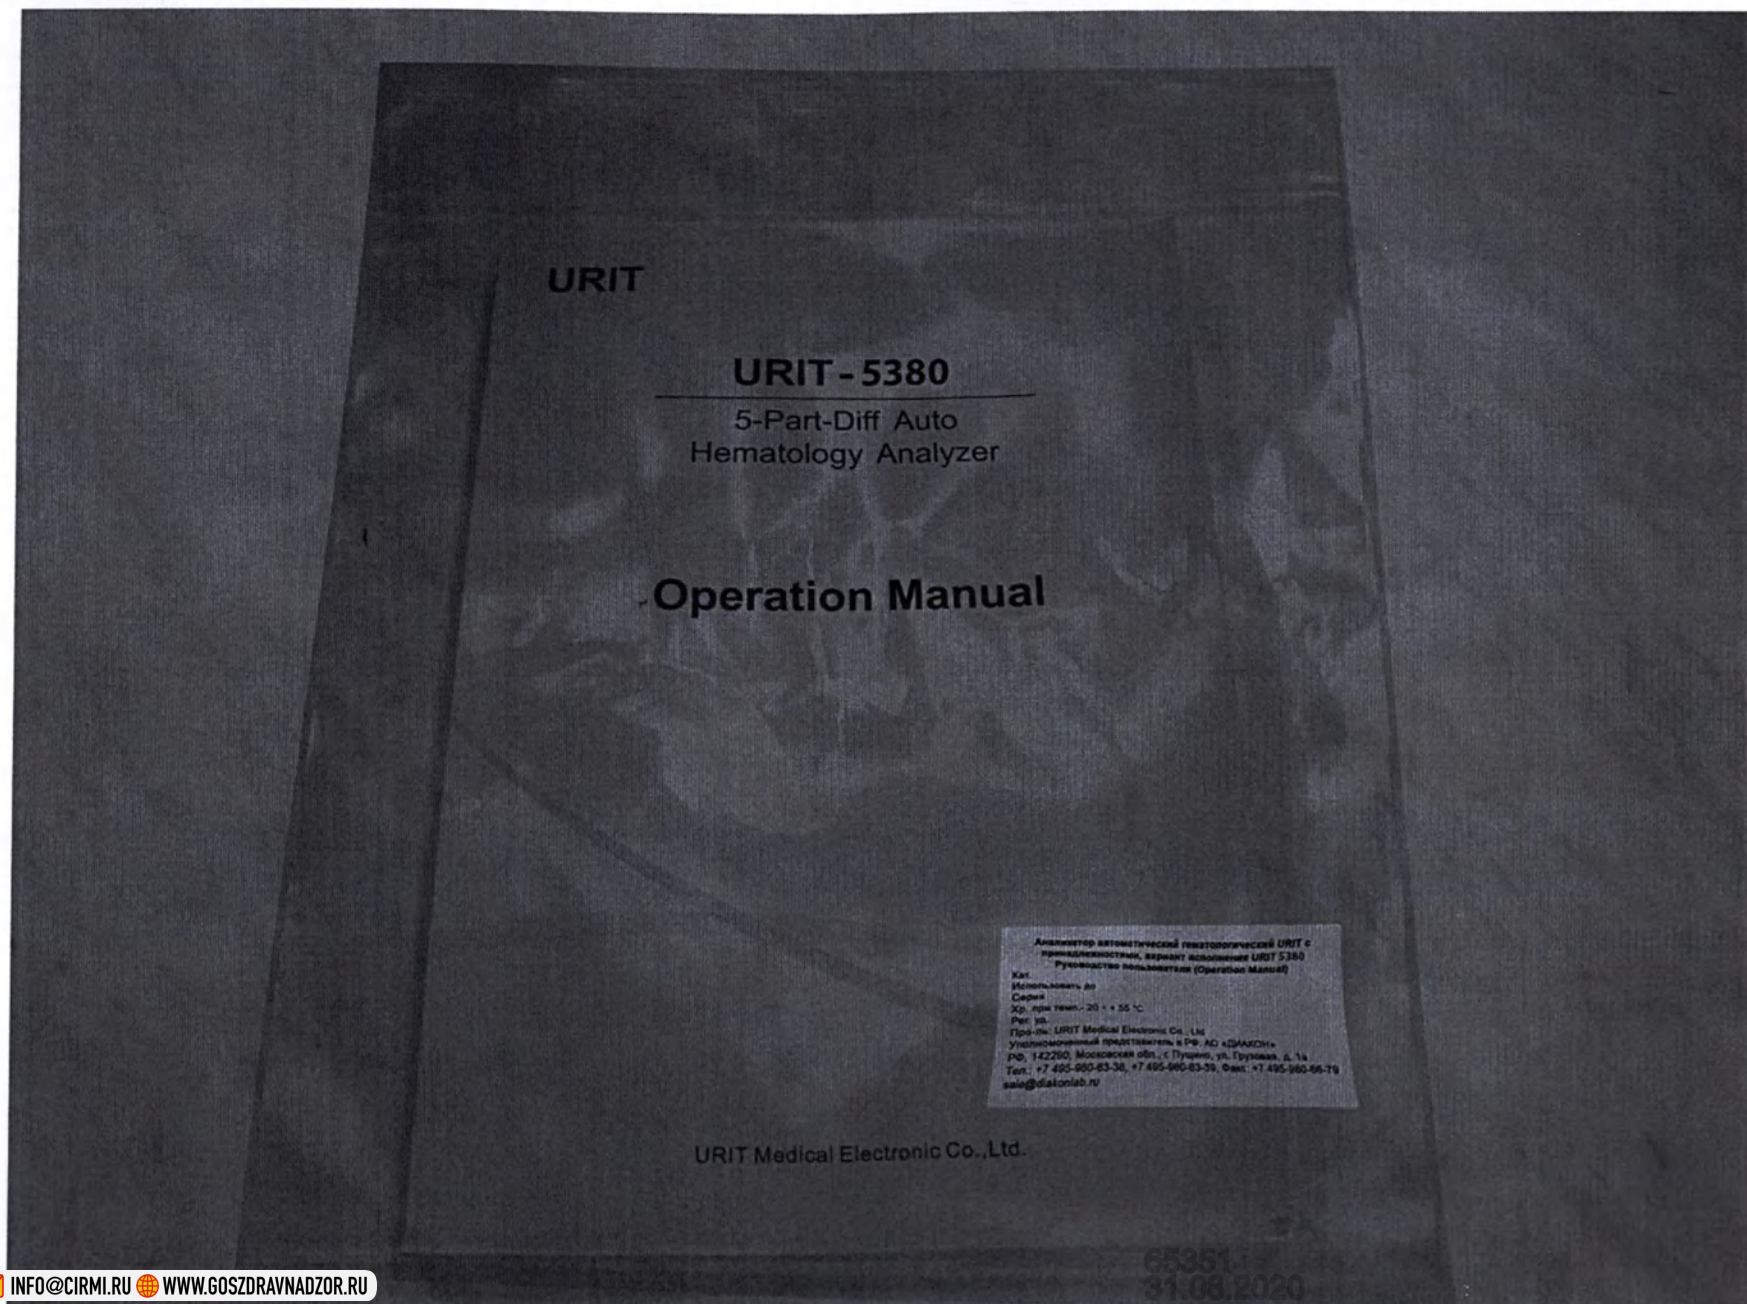


3. Кабель питания для анализатора автоматического гематологического URIT (Power Cord For URIT Auto Hematology Analyzer).



4. Провод заземления (Grounding Wire).

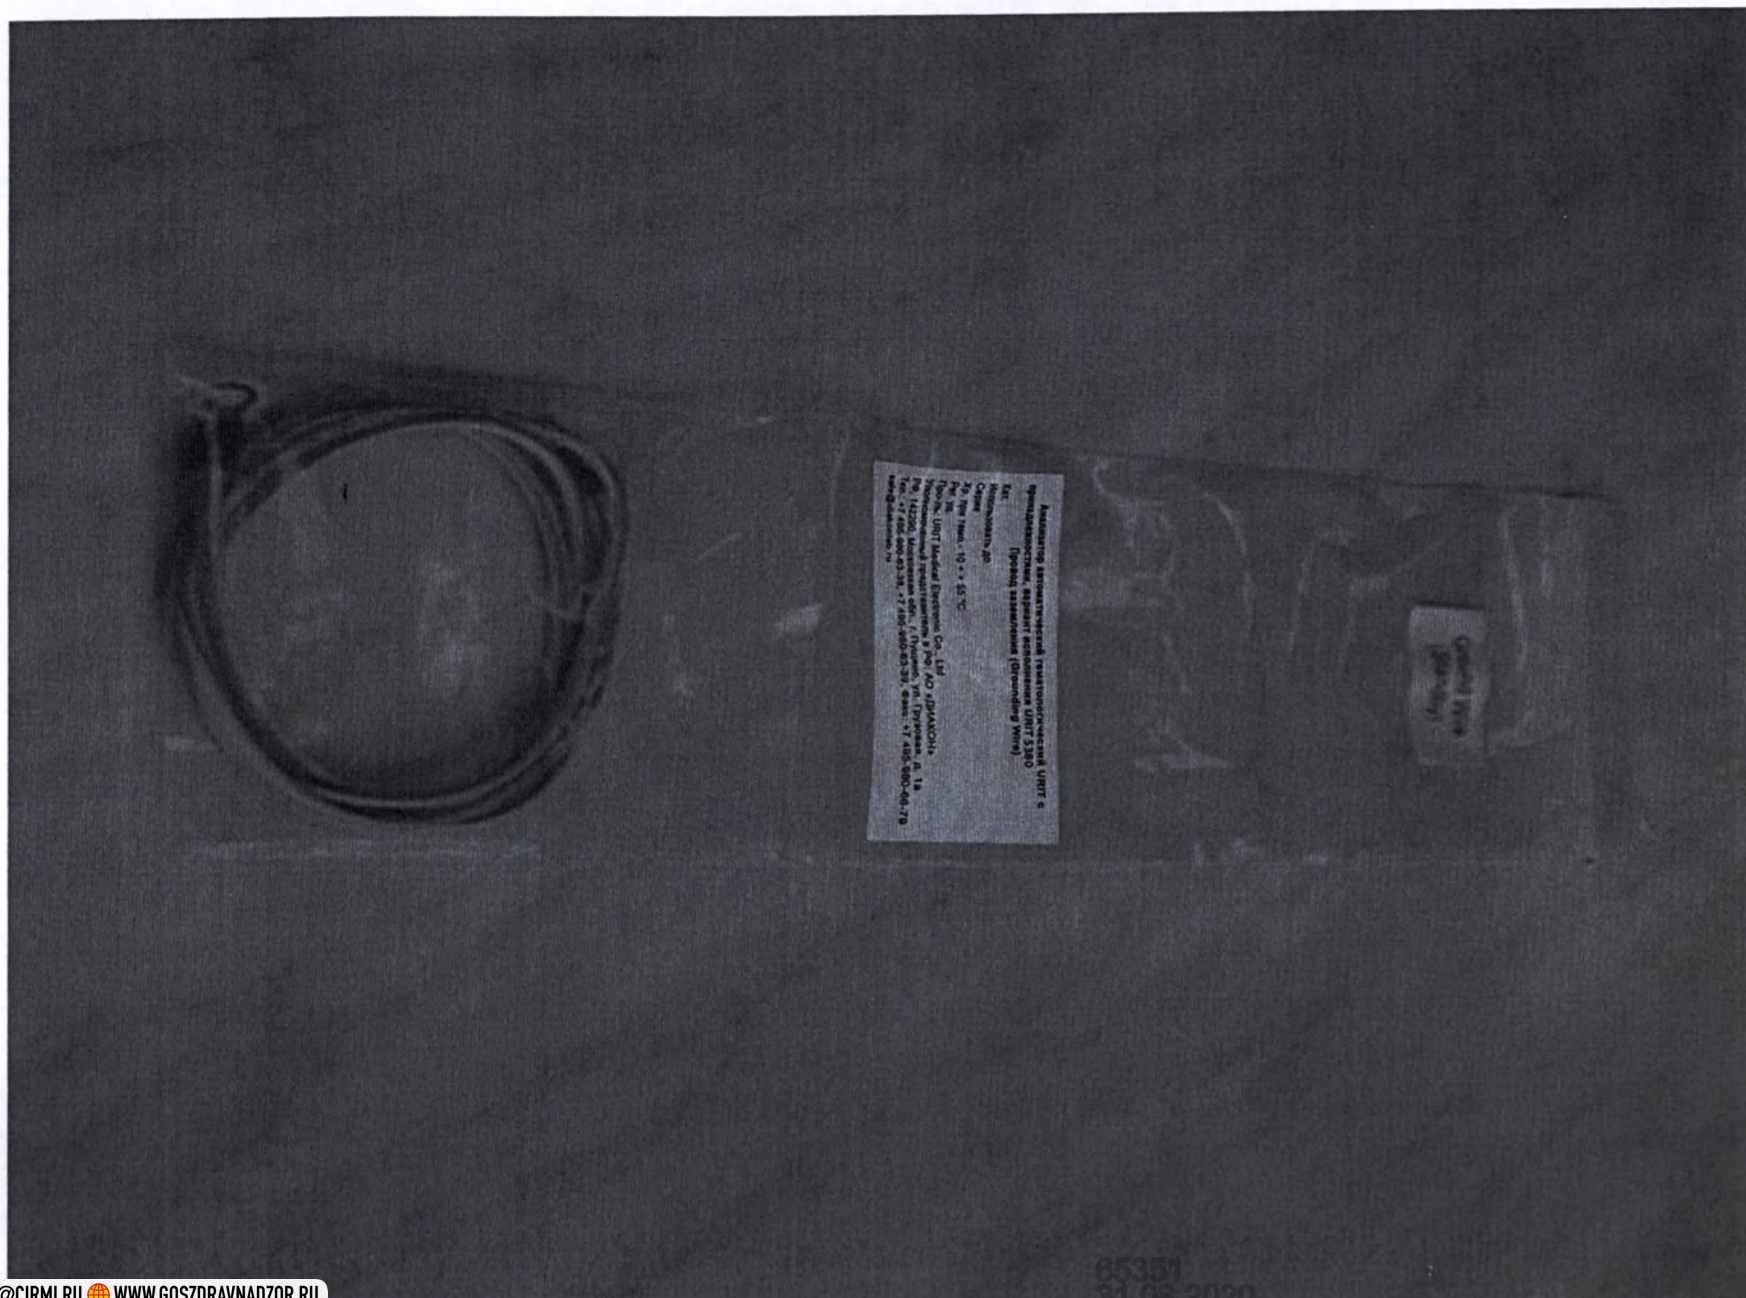

5. Трубка слива отходов с датчиком уровня (Waste Outlet Tubing With Cap and Sensor Cable).

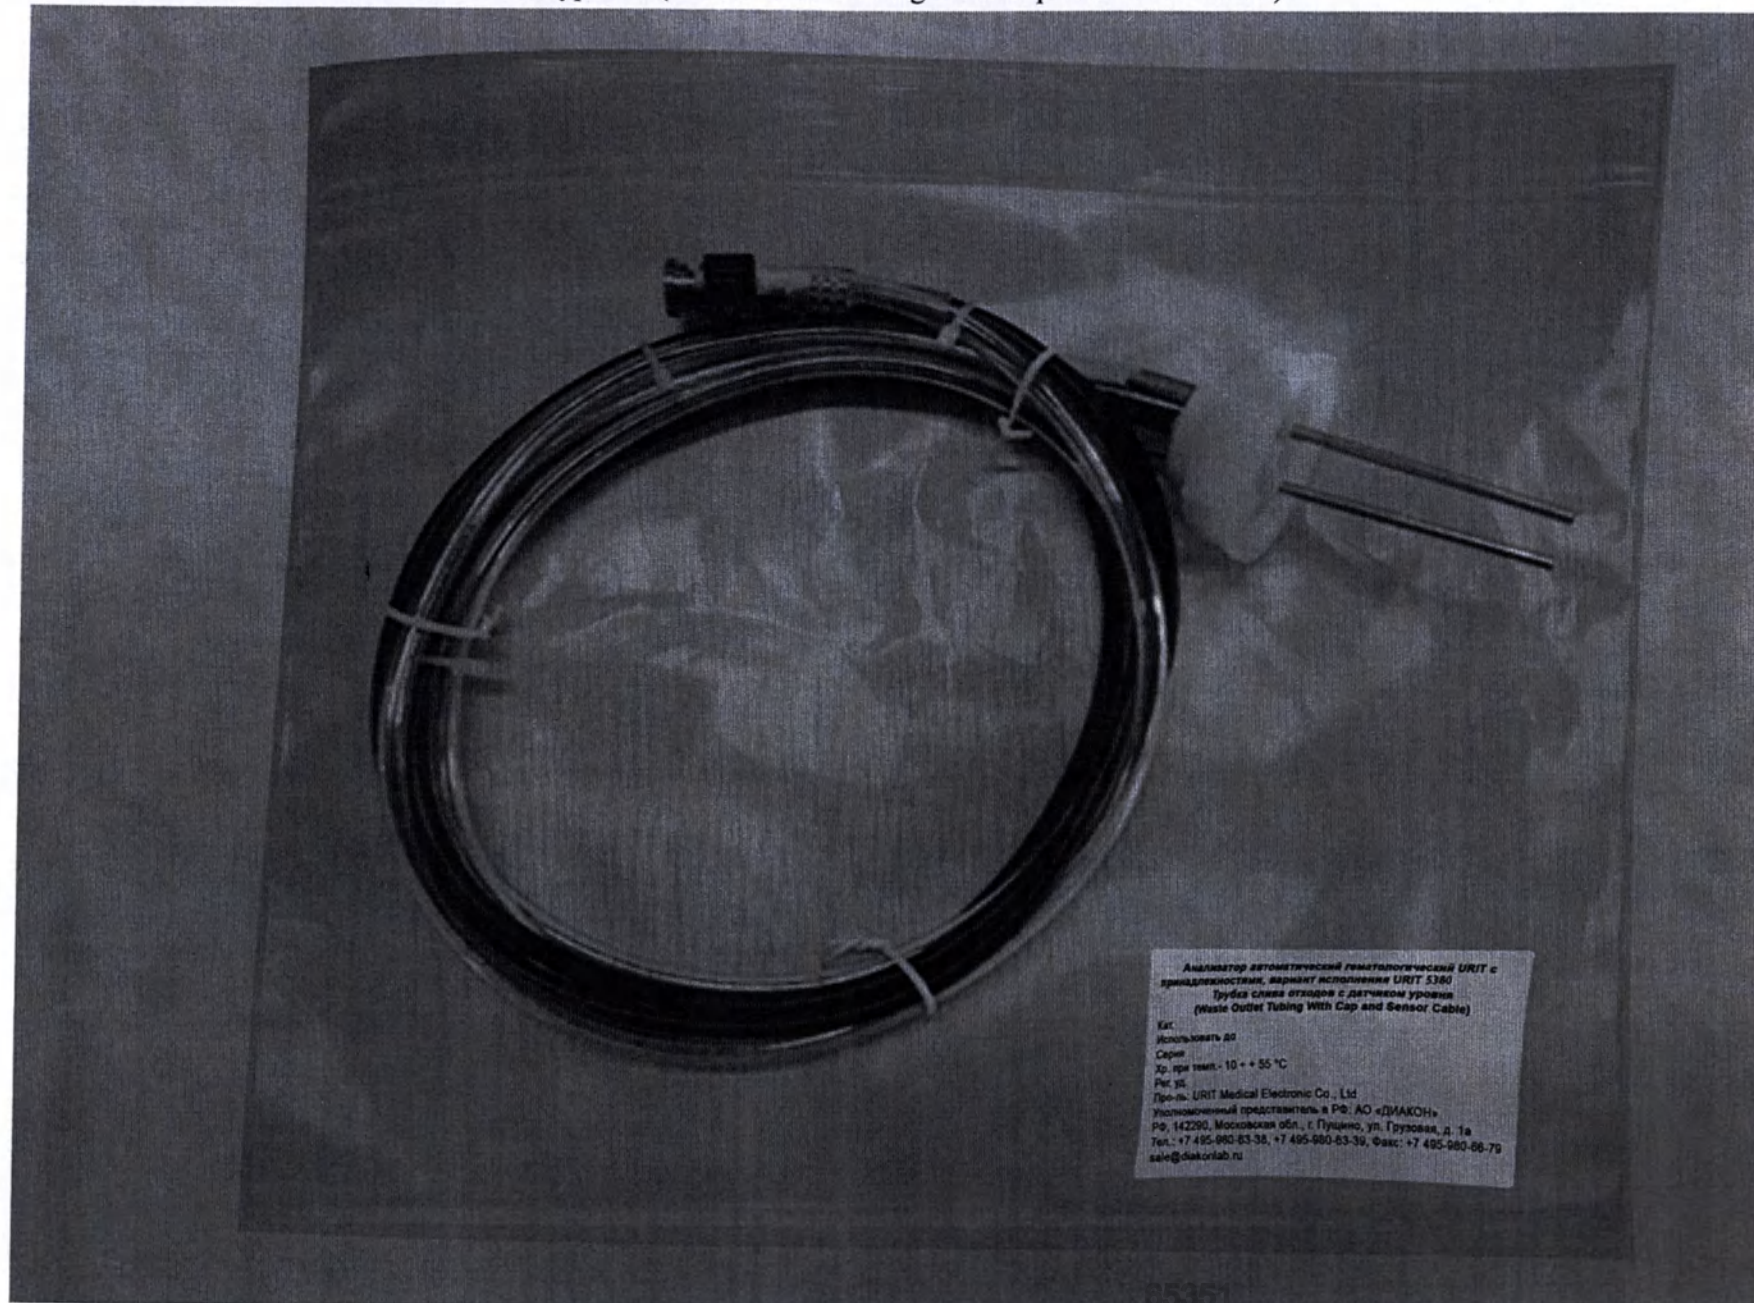

Анализатор автоматический гематологический URIT с  
крандужностями, вариант исполнения URIT 5360  
Трубка слива отходов с датчиком уровня  
(Waste Outlet Tubing With Cap and Sensor Cable)


Кат.  
Использовать до  
Серия  
Хр. при темп. - 10...+55 °C  
Рес. 3/6  
Поставщик: URIT Medical Electronic Co., Ltd.  
Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»  
РФ, 142290, Московская обл., г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а  
Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-70  
sales@diakonlab.ru

## 6. Предохранители 15A (Fuse T3.15AL 250V).

Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 5380  
Предохранители 15A (Fuse T3.15AL 250V)

Кат.  
Использовать до  
Серия  
Хр. при темп. -10 + +55 °C  
Рес. 3л  
Прод-ль. URIT Medical Electronic Co., Ltd  
Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»  
РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а  
Тел.: +7 495-990-63-38, +7 495-990-63-39, Факс: +7 495-990-66-70  
sale@diakonlab.ru


7. Трубка для подачи гемолизирующего раствора с крышкой (Lyse Inlet Tube With Cap).

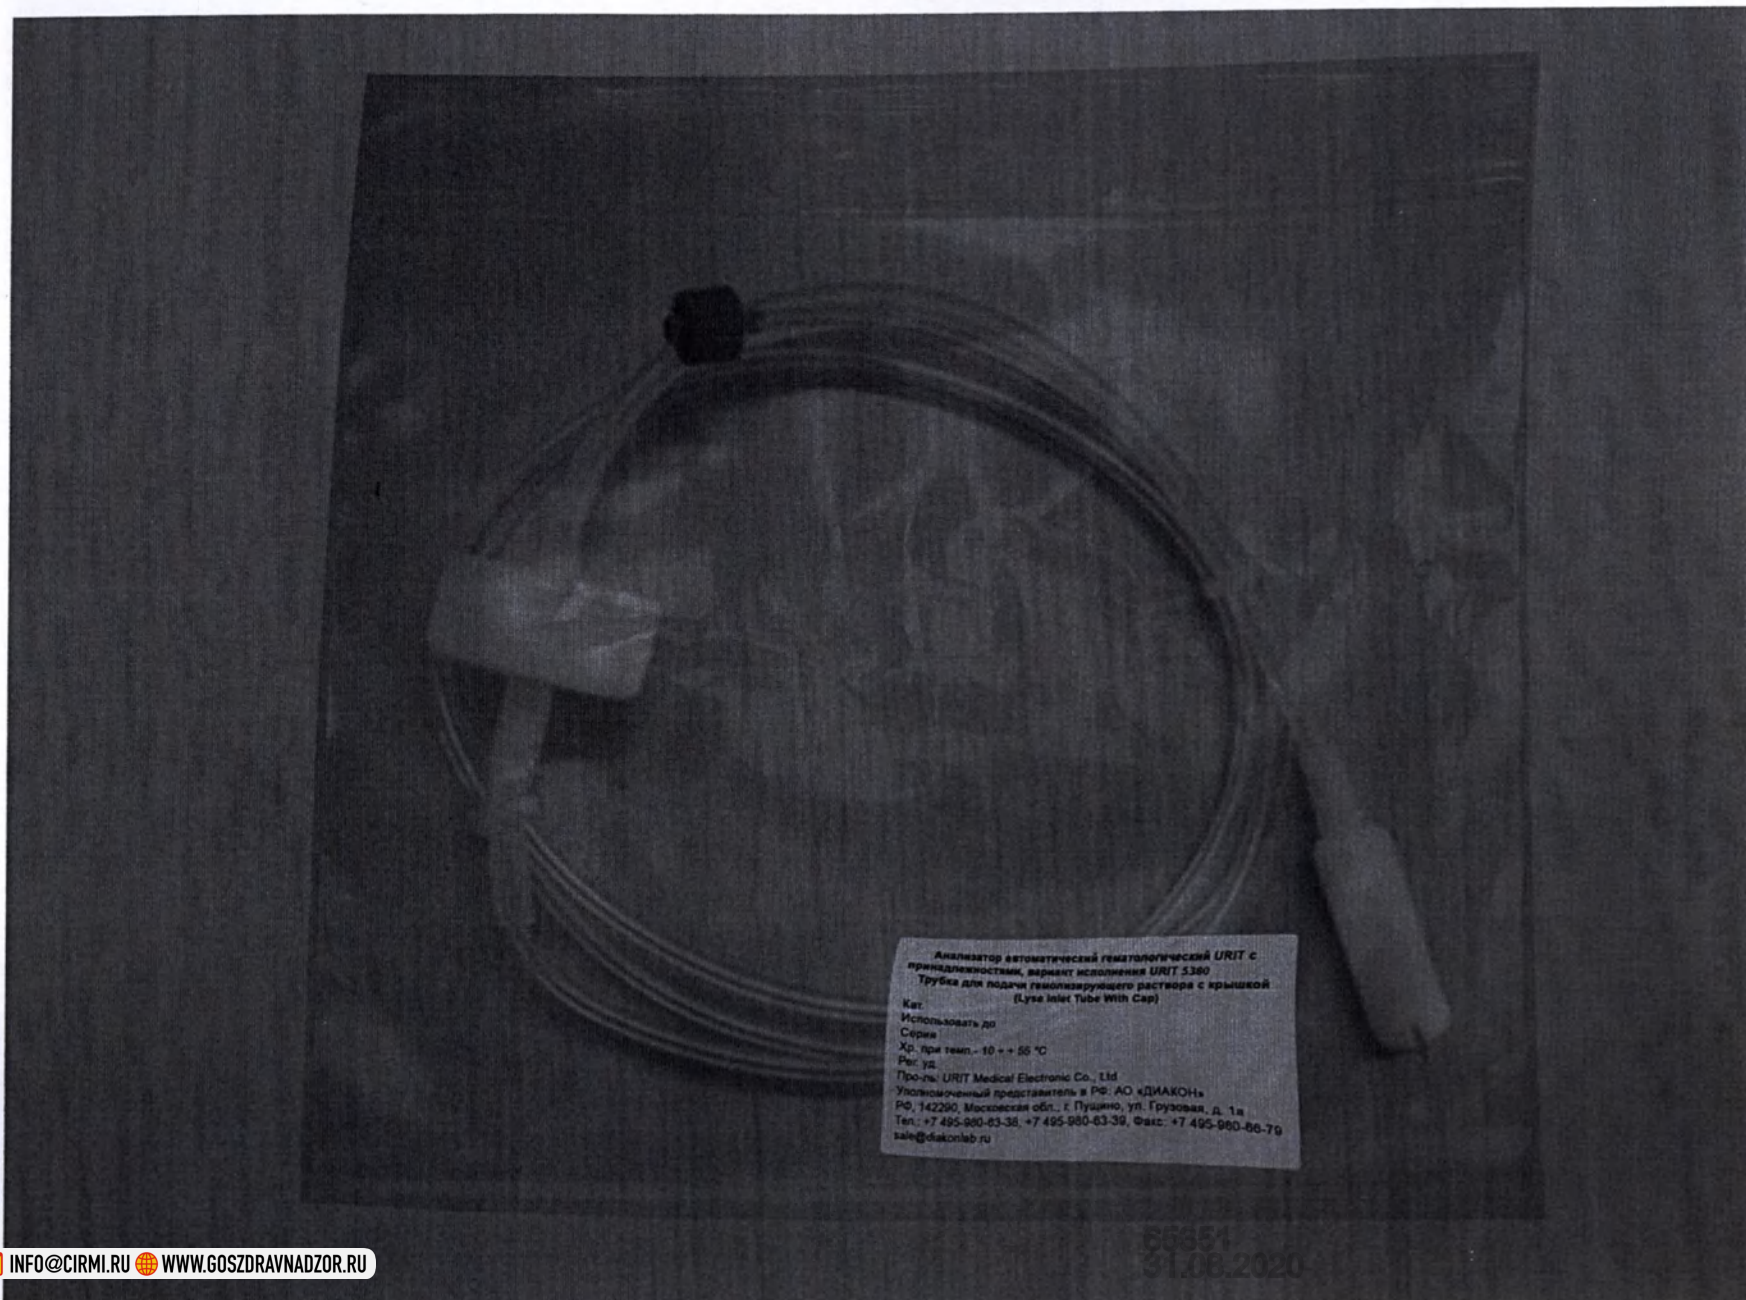


Анализатор автоматический гематологический URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 5380  
Трубка для подачи гемолизирующего раствора с крышкой  
(Lyse Inlet Tube With Cap)

Кат.  
Использовать до  
Серия  
Хр. при темп. - 10 + + 55 °C  
Рег. уд.  
Про-из: URIT Medical Electronic Co., Ltd  
Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»  
РФ, 142290, Московская обл., г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а  
Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79  
sale@diakonlab.ru


8. Трубка для подачи разбавителя с крышкой (Diluent Inlet Tube With Cap).

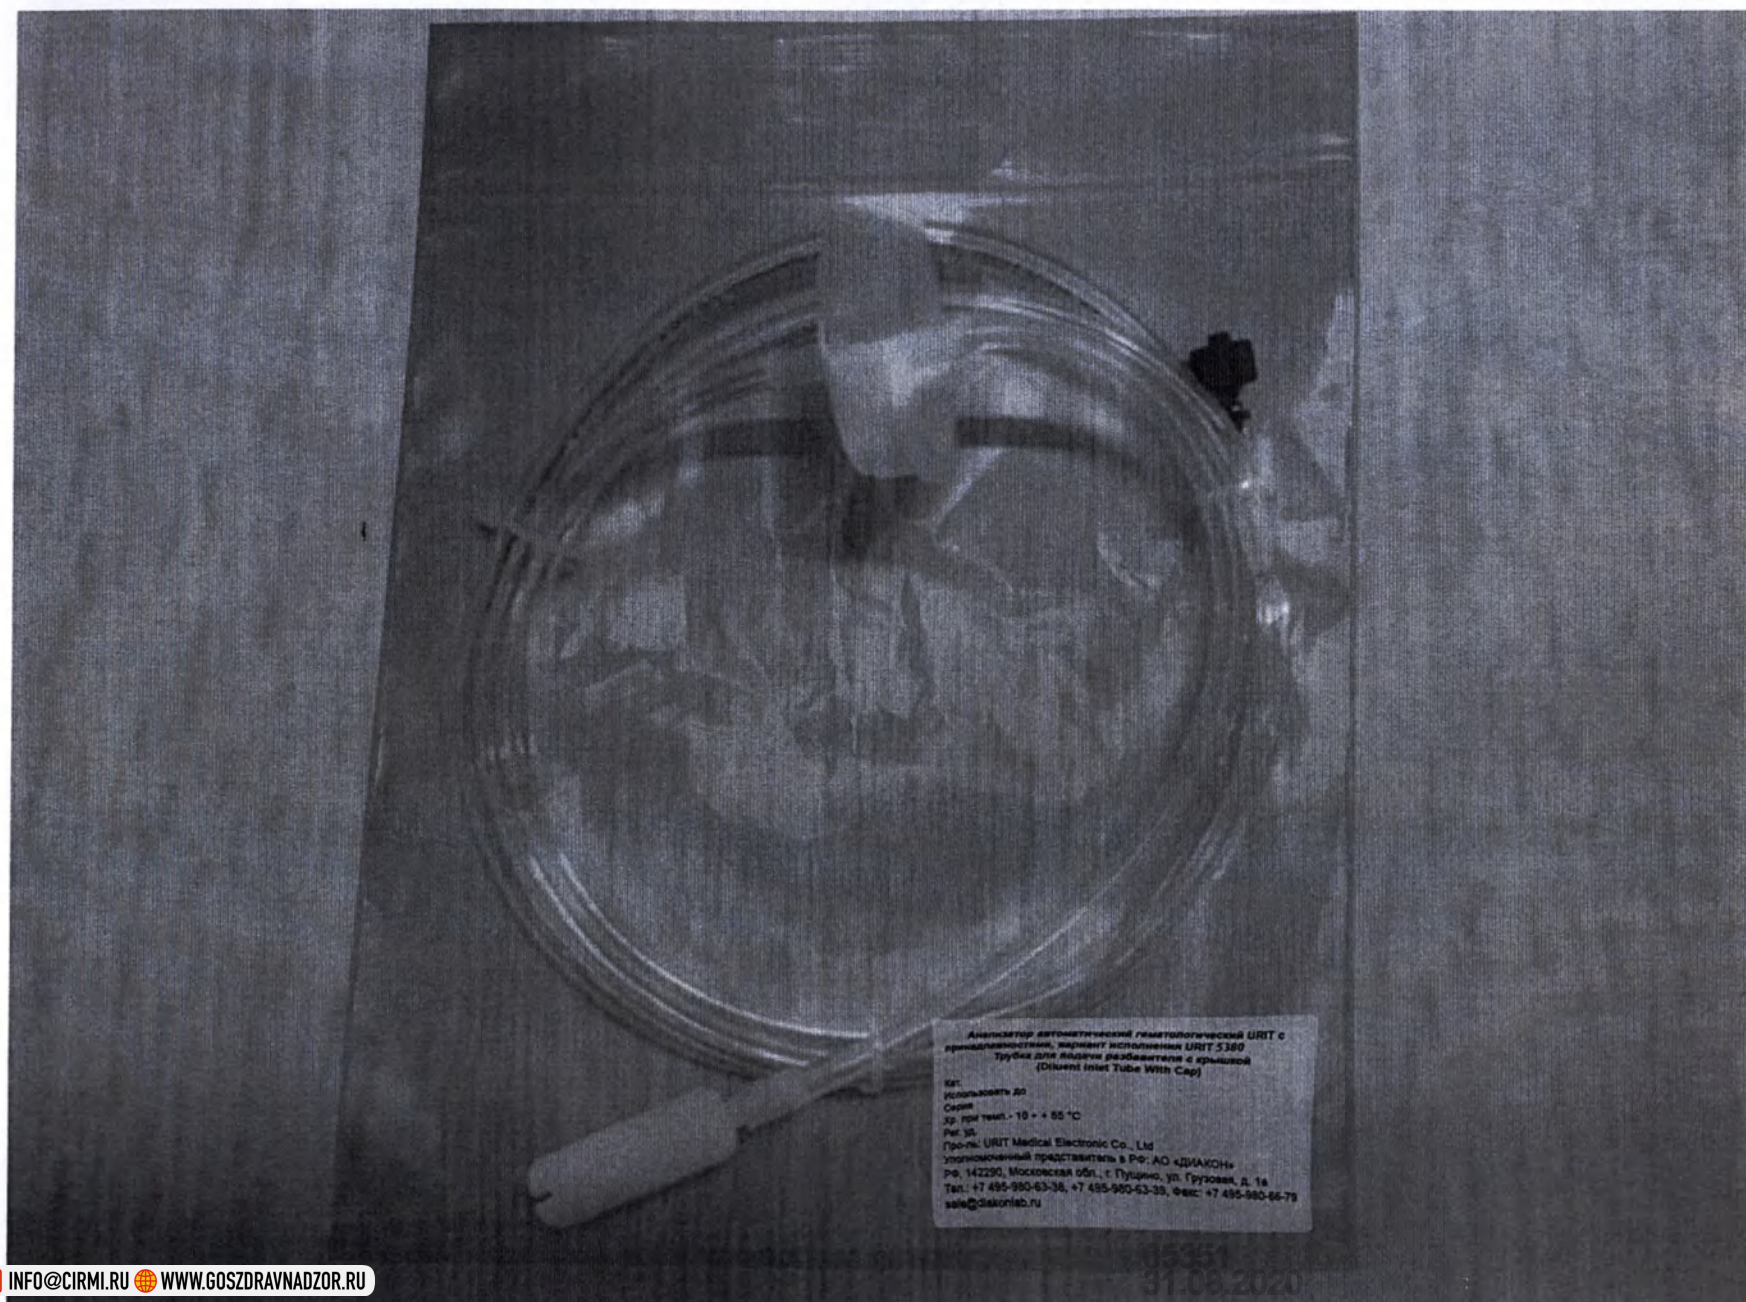

9. Трубка для подачи фокусирующего раствора (Sheath Inlet Tubing).

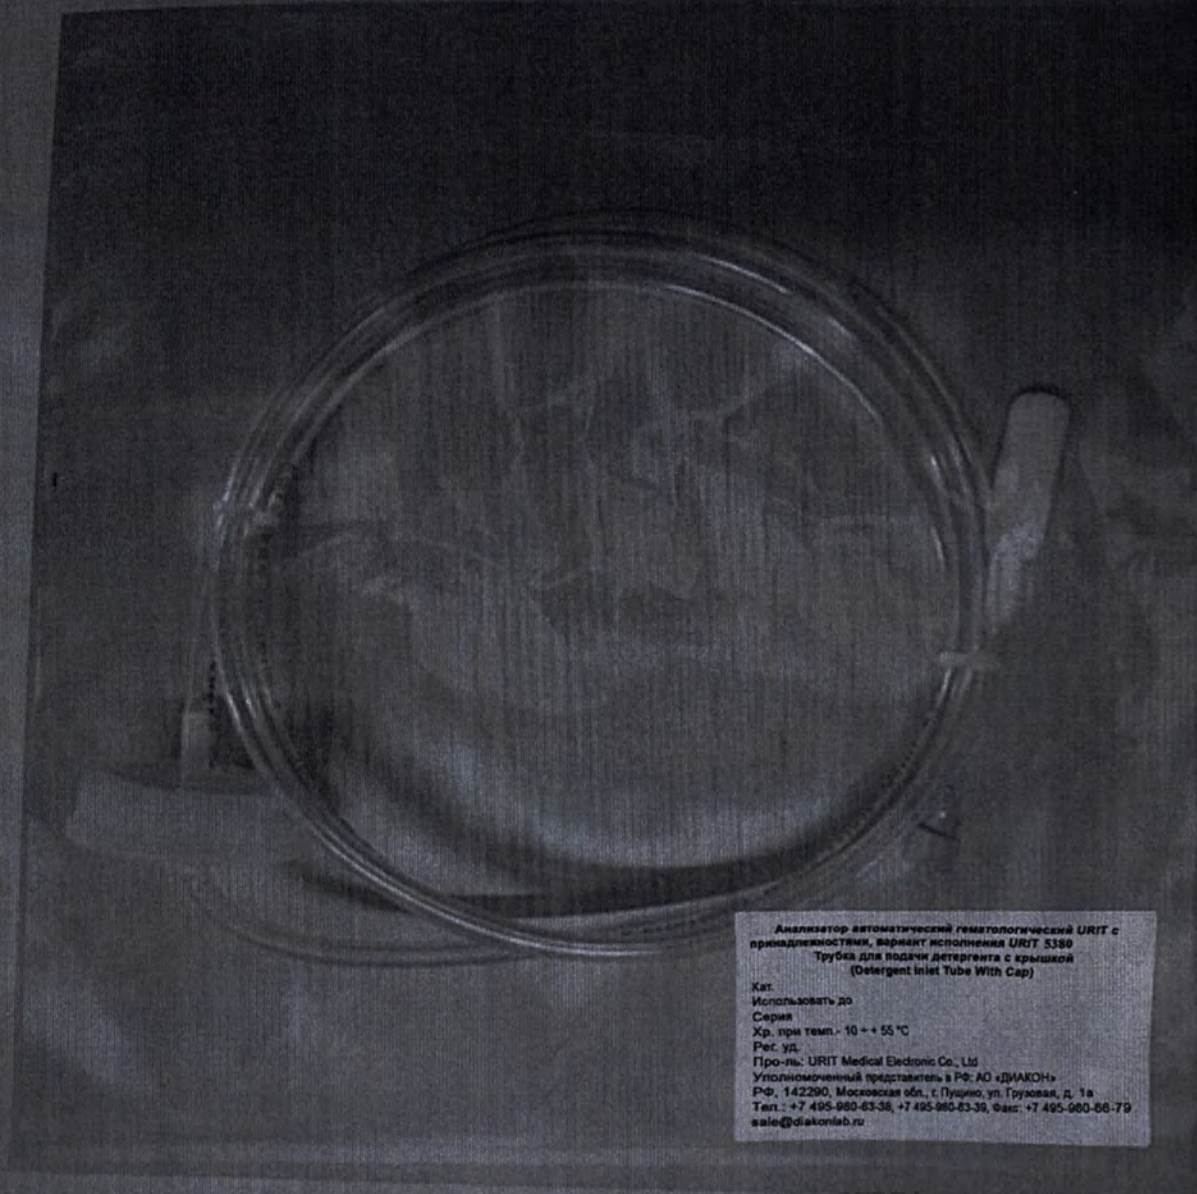


10. Трубка для подачи детергента с крышкой (Detergent Inlet Tube With Cap).

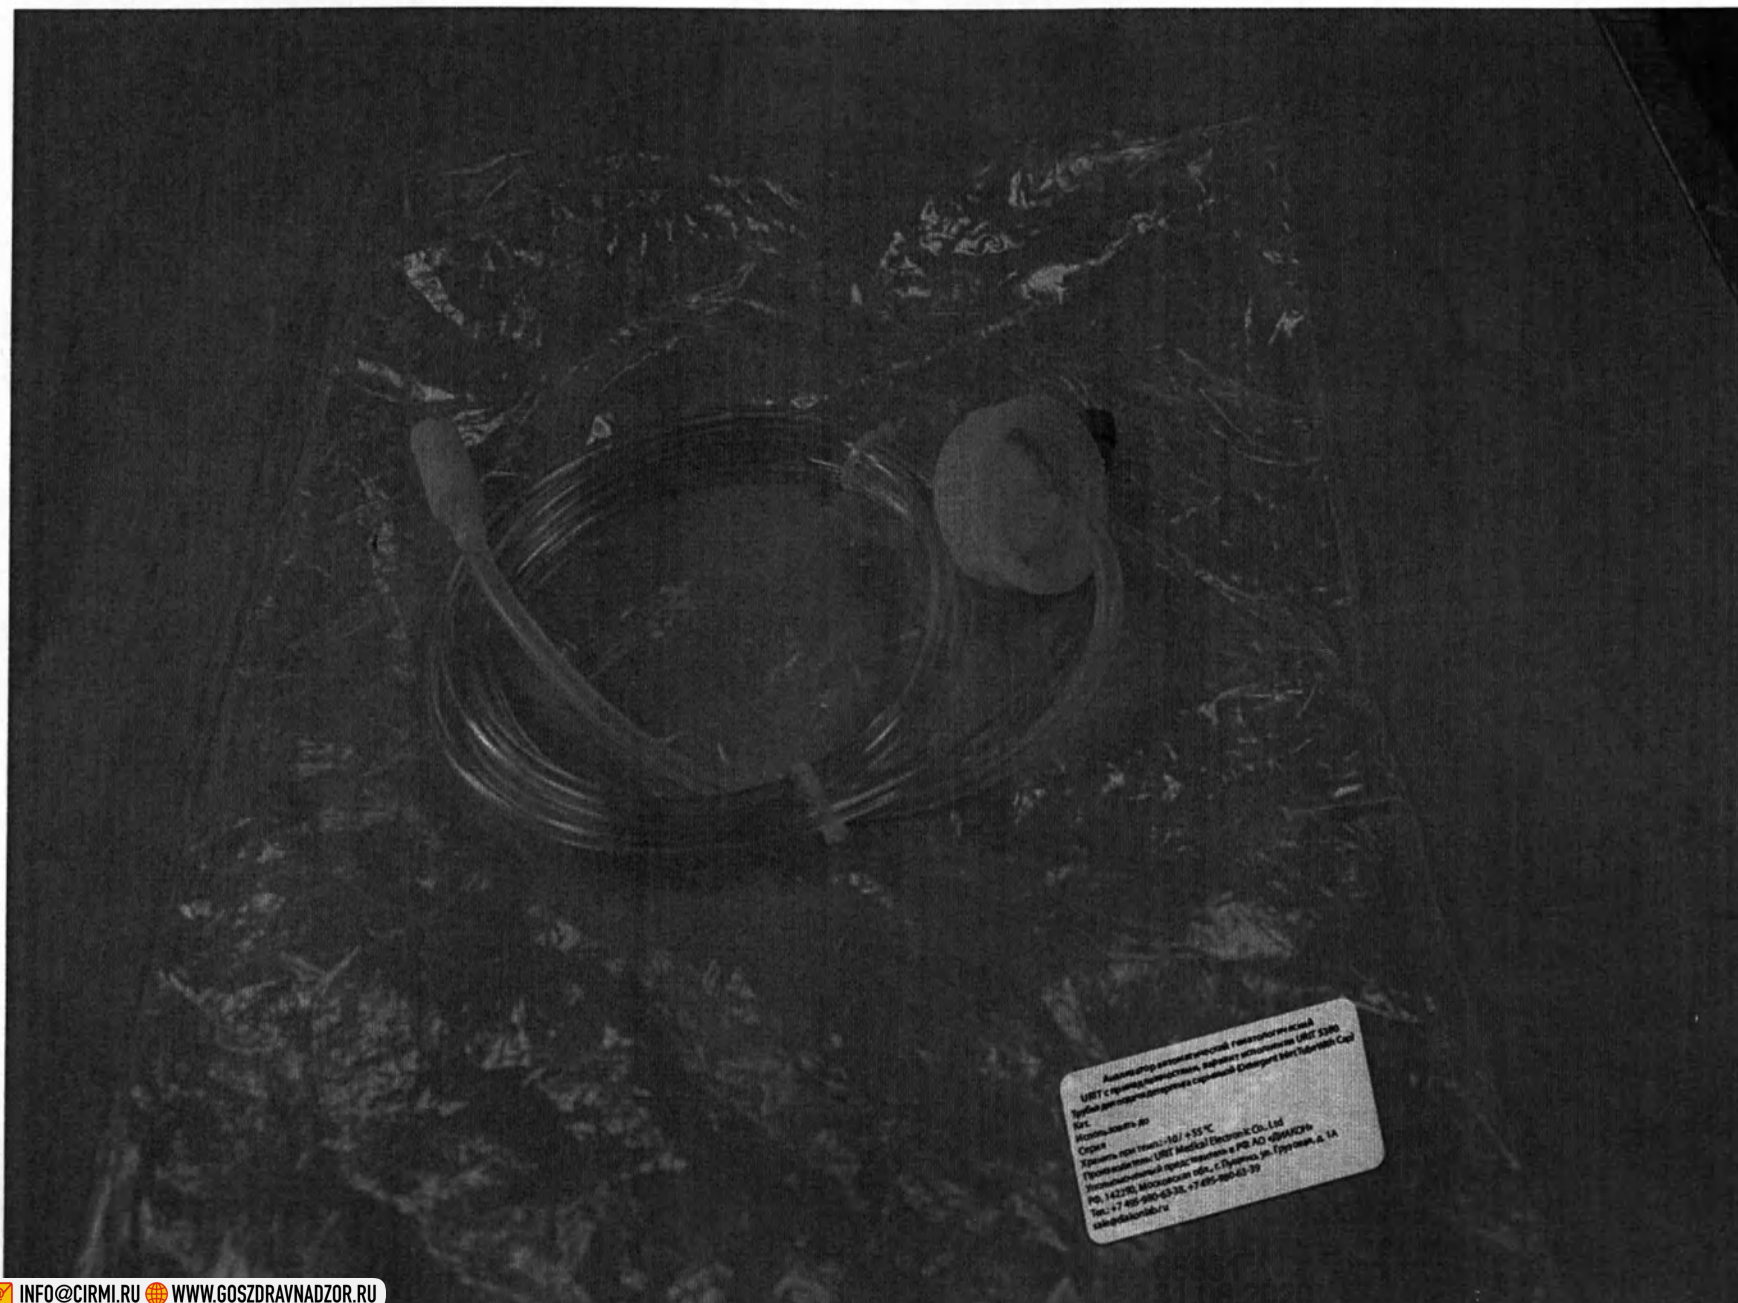


Автоматическая система очистки желудочно-кишечного тракта  
LIFT с автоматическим дозатором, датчиком температуры LIFT 5385  
Трубка для подачи детергента с крышкой Detergent Inlet Tube With Cap  
Вид:  
Используется до:  
Срок:  
Хранить при температуре: +10 / +35 °C  
Примечание: LIFT Medical Electronics OJSC  
Земельный участок расположен в РФ АО «СИБИРЬ»  
РФ, 142780, Московская обл., с. Пушкино, ул. Горького, д. 14  
Тел.: +7 495 980-65-38, +7 495 980-65-39  
info@lifter.ru

## 11. Канистра для отходов (Waste Container)

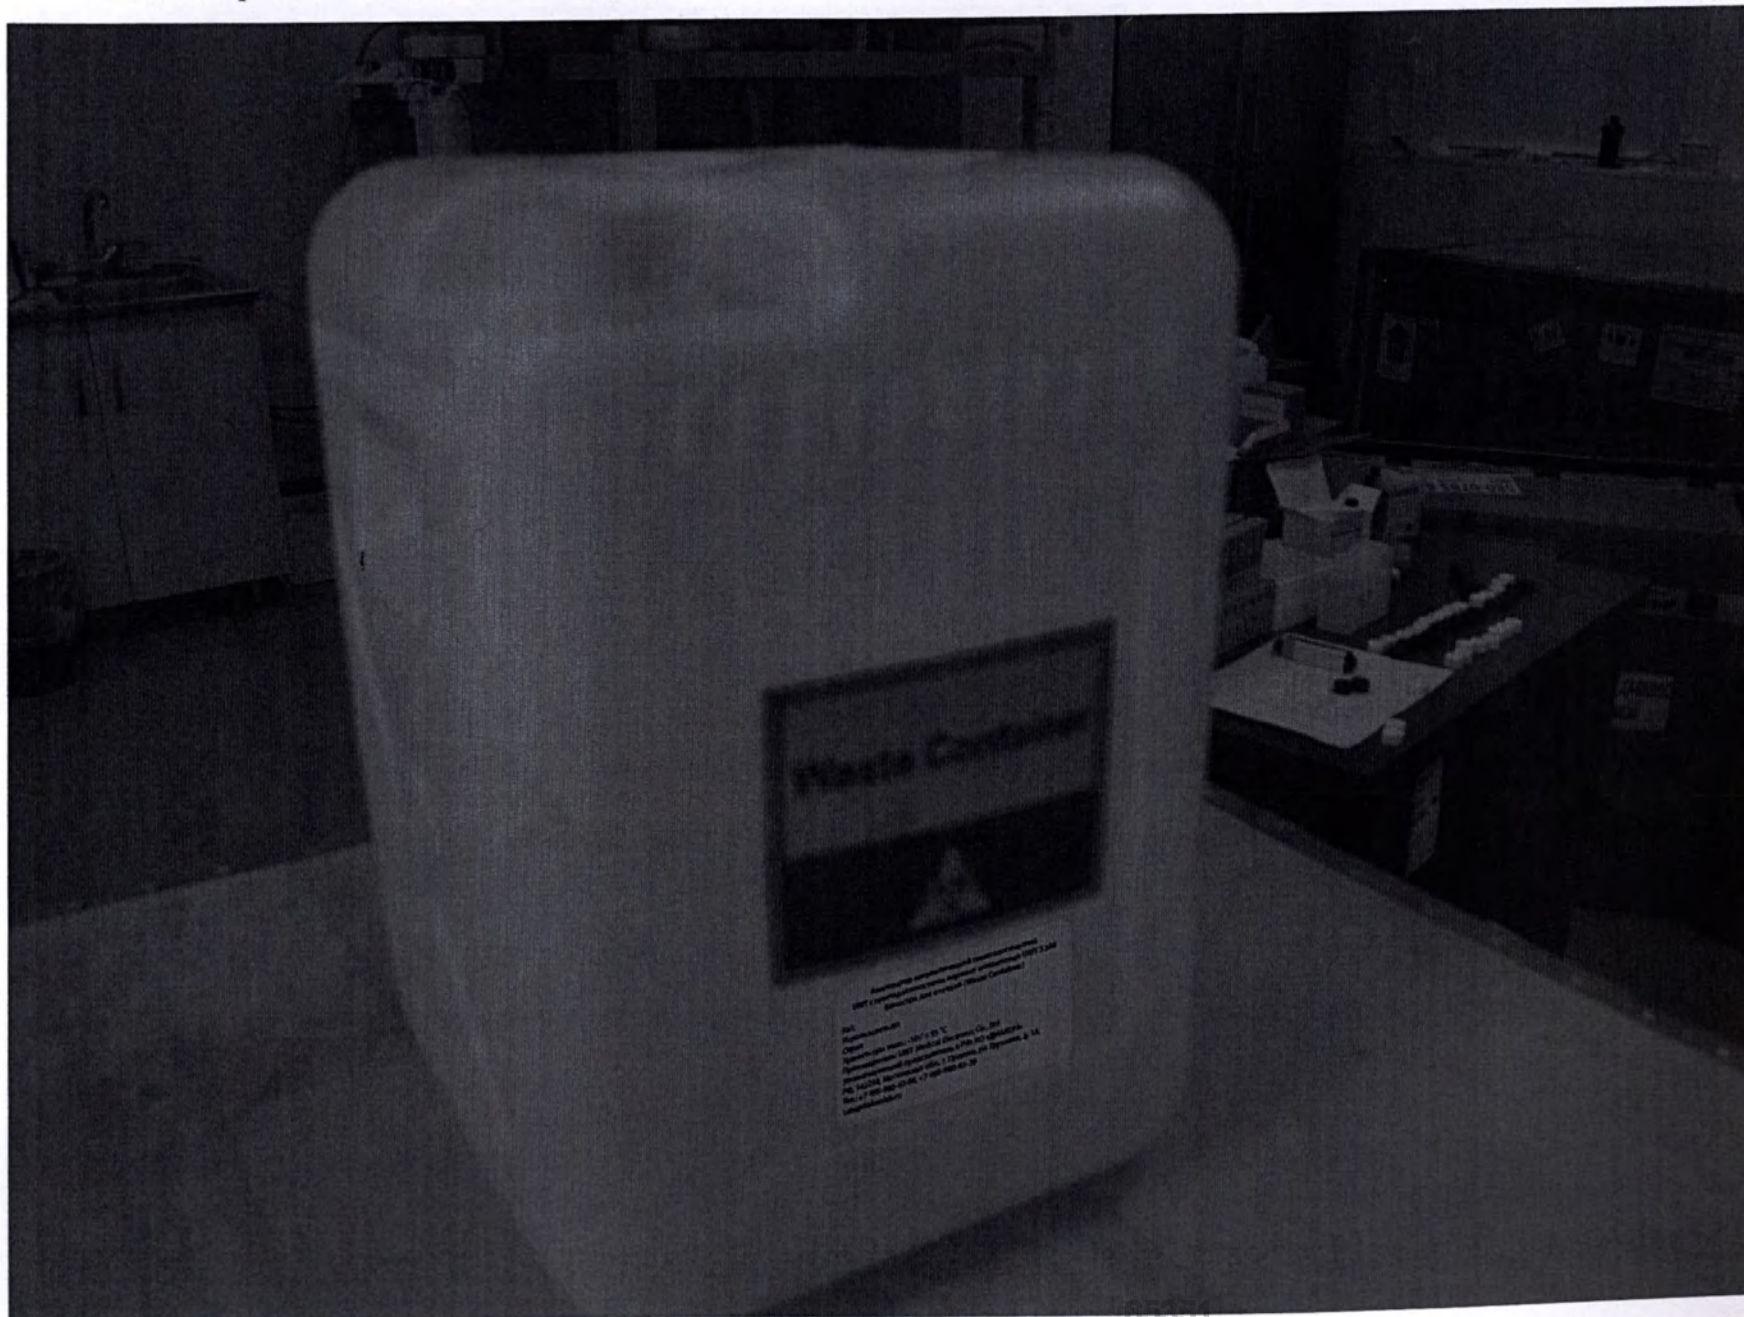

## 12. Смазка (Grease).

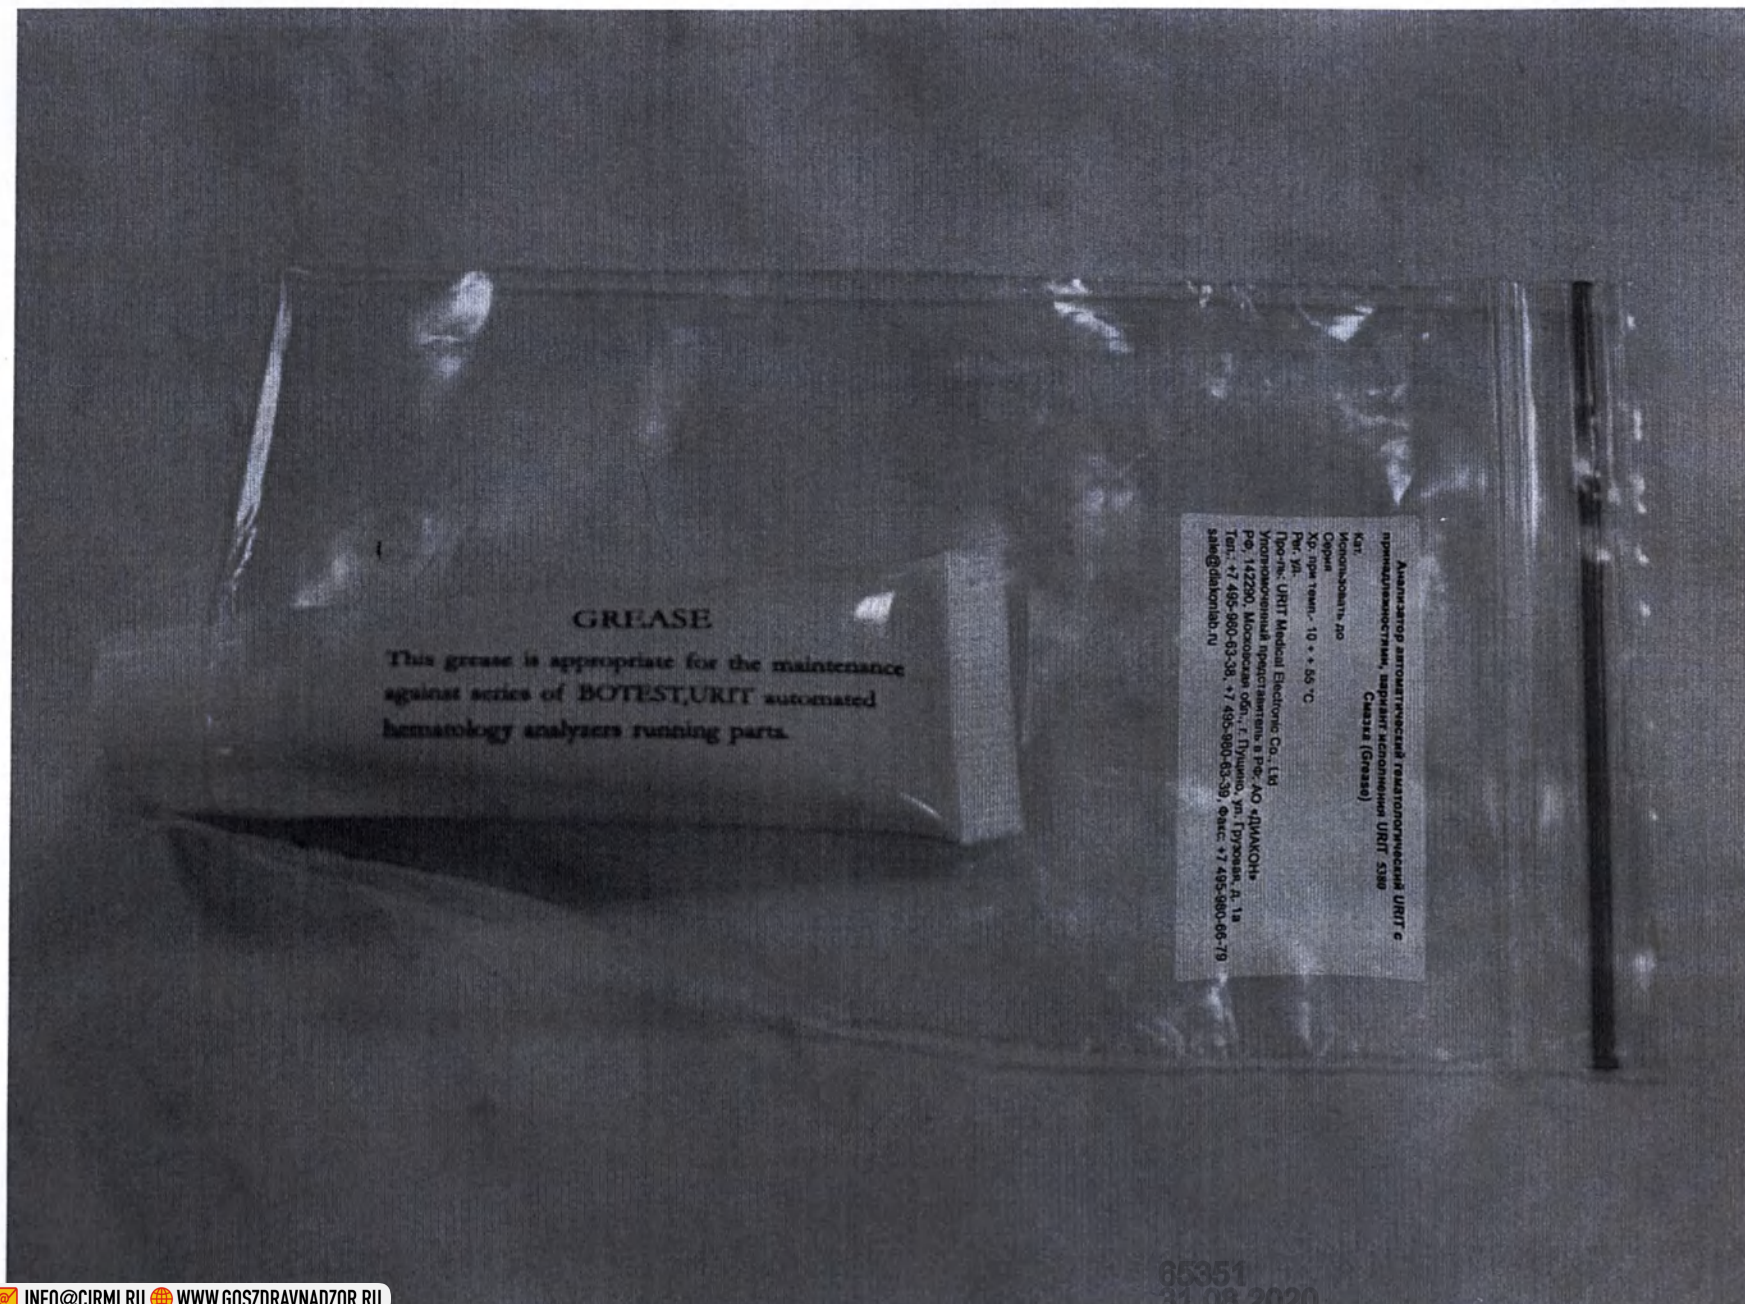

### 13. Фильтр (Filter).

Анализатор автоматический гематологический URIT с  
принадлежностями, вариант исполнения URIT 5380  
Фильтр (Filter)

Кат.

Использовать до

Серия

Хр. при темп. - 10 + + 55 °C

Рег. уд.

Про-ль: URIT Medical Electronic Co., Ltd


Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39, Факс: +7 495-980-66-79

sale@diakonlab.ru


14. Кольцо уплотнительное для шприца дозирования разбавителя (большое) (Diluent Syringe Seal Ring, big).

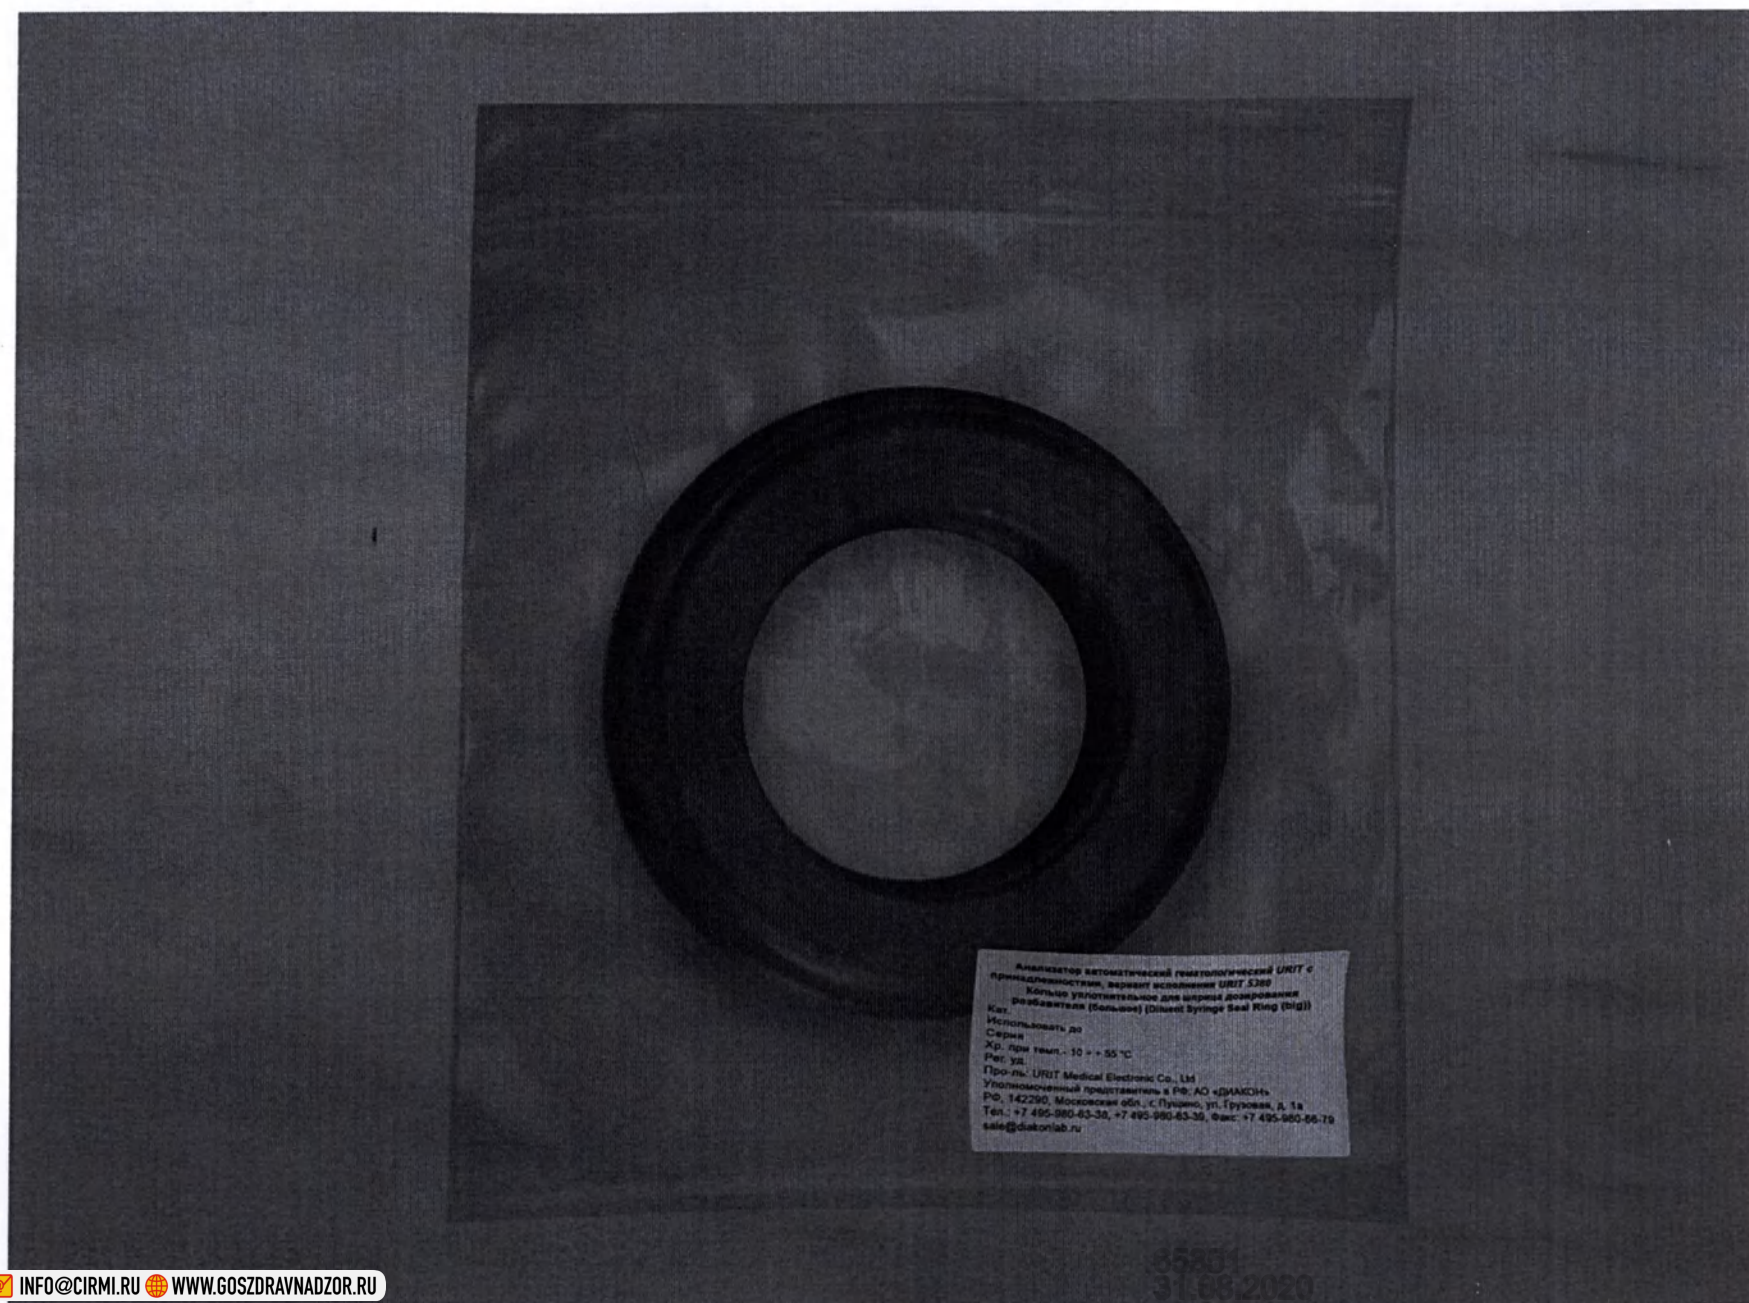

Анализатор автоматический гематологический URIT с  
принадлежностями, вариант исполнения URIT 5200  
Кольцо уплотнительное для шприца дозирования  
разбавителя (большое) (Diluent Syringe Seal Ring (big))  
Кат.  
Использовать до  
Серия  
Хр. темп. - 10 ... + 55 °C  
Рег. уст.  
Пр-ль: URIT Medical Electronics Co., Ltd  
Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»  
РФ, 142290, Московская обл., с. Пущино, ул. Грузовая, д. 1а  
Тел.: +7 495-980-63-30, +7 495-980-63-30, Факс: +7 495-980-66-79  
sales@diakonlab.ru

35801  
31.08.2020


15. Кольцо уплотнительное для шприца дозирования гемолизирующего раствора (малое) (Lyse Syringe Seal Ring, small).

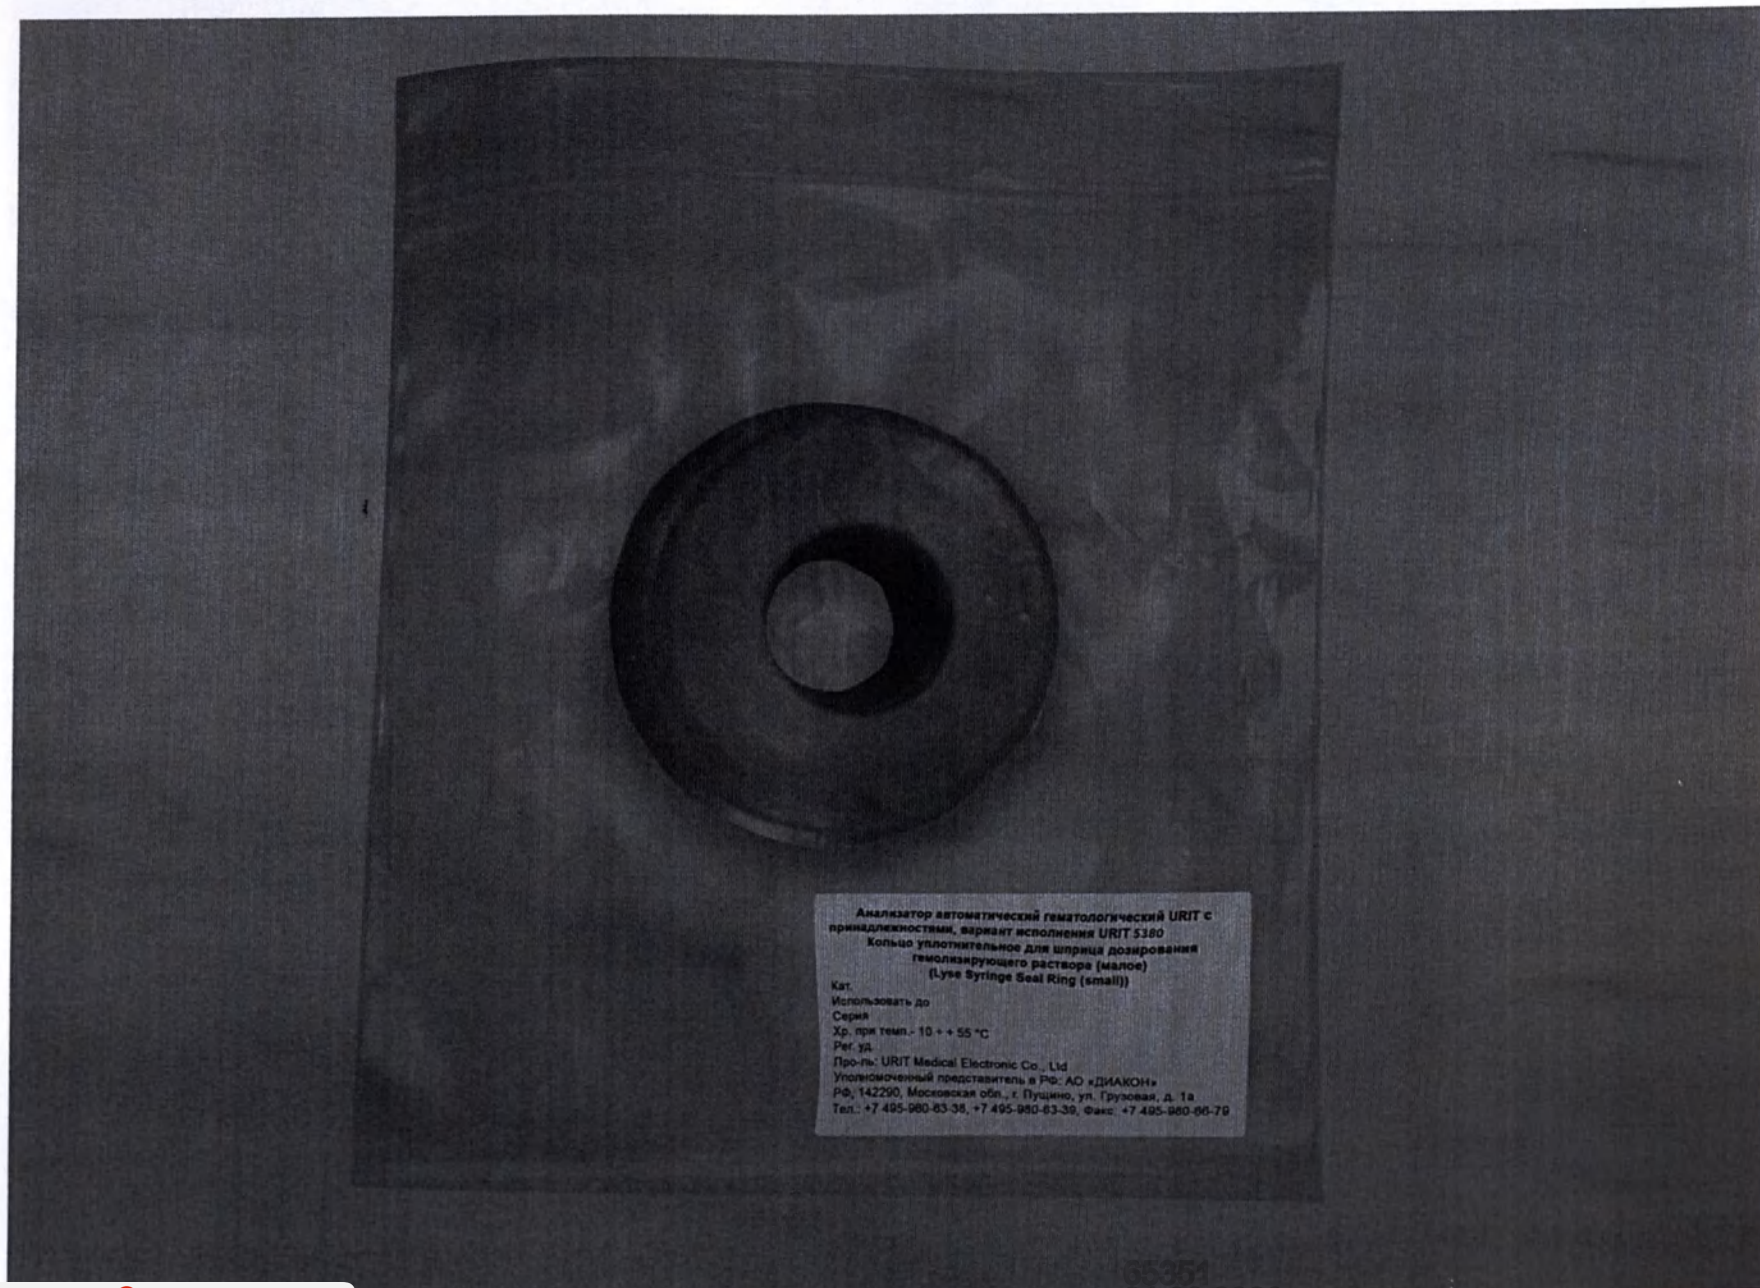

16. Пробирка пластиковая одноразовая (Disposable Plastic Test Tube).



17. Штатив для пробирок (Test Tube rack).

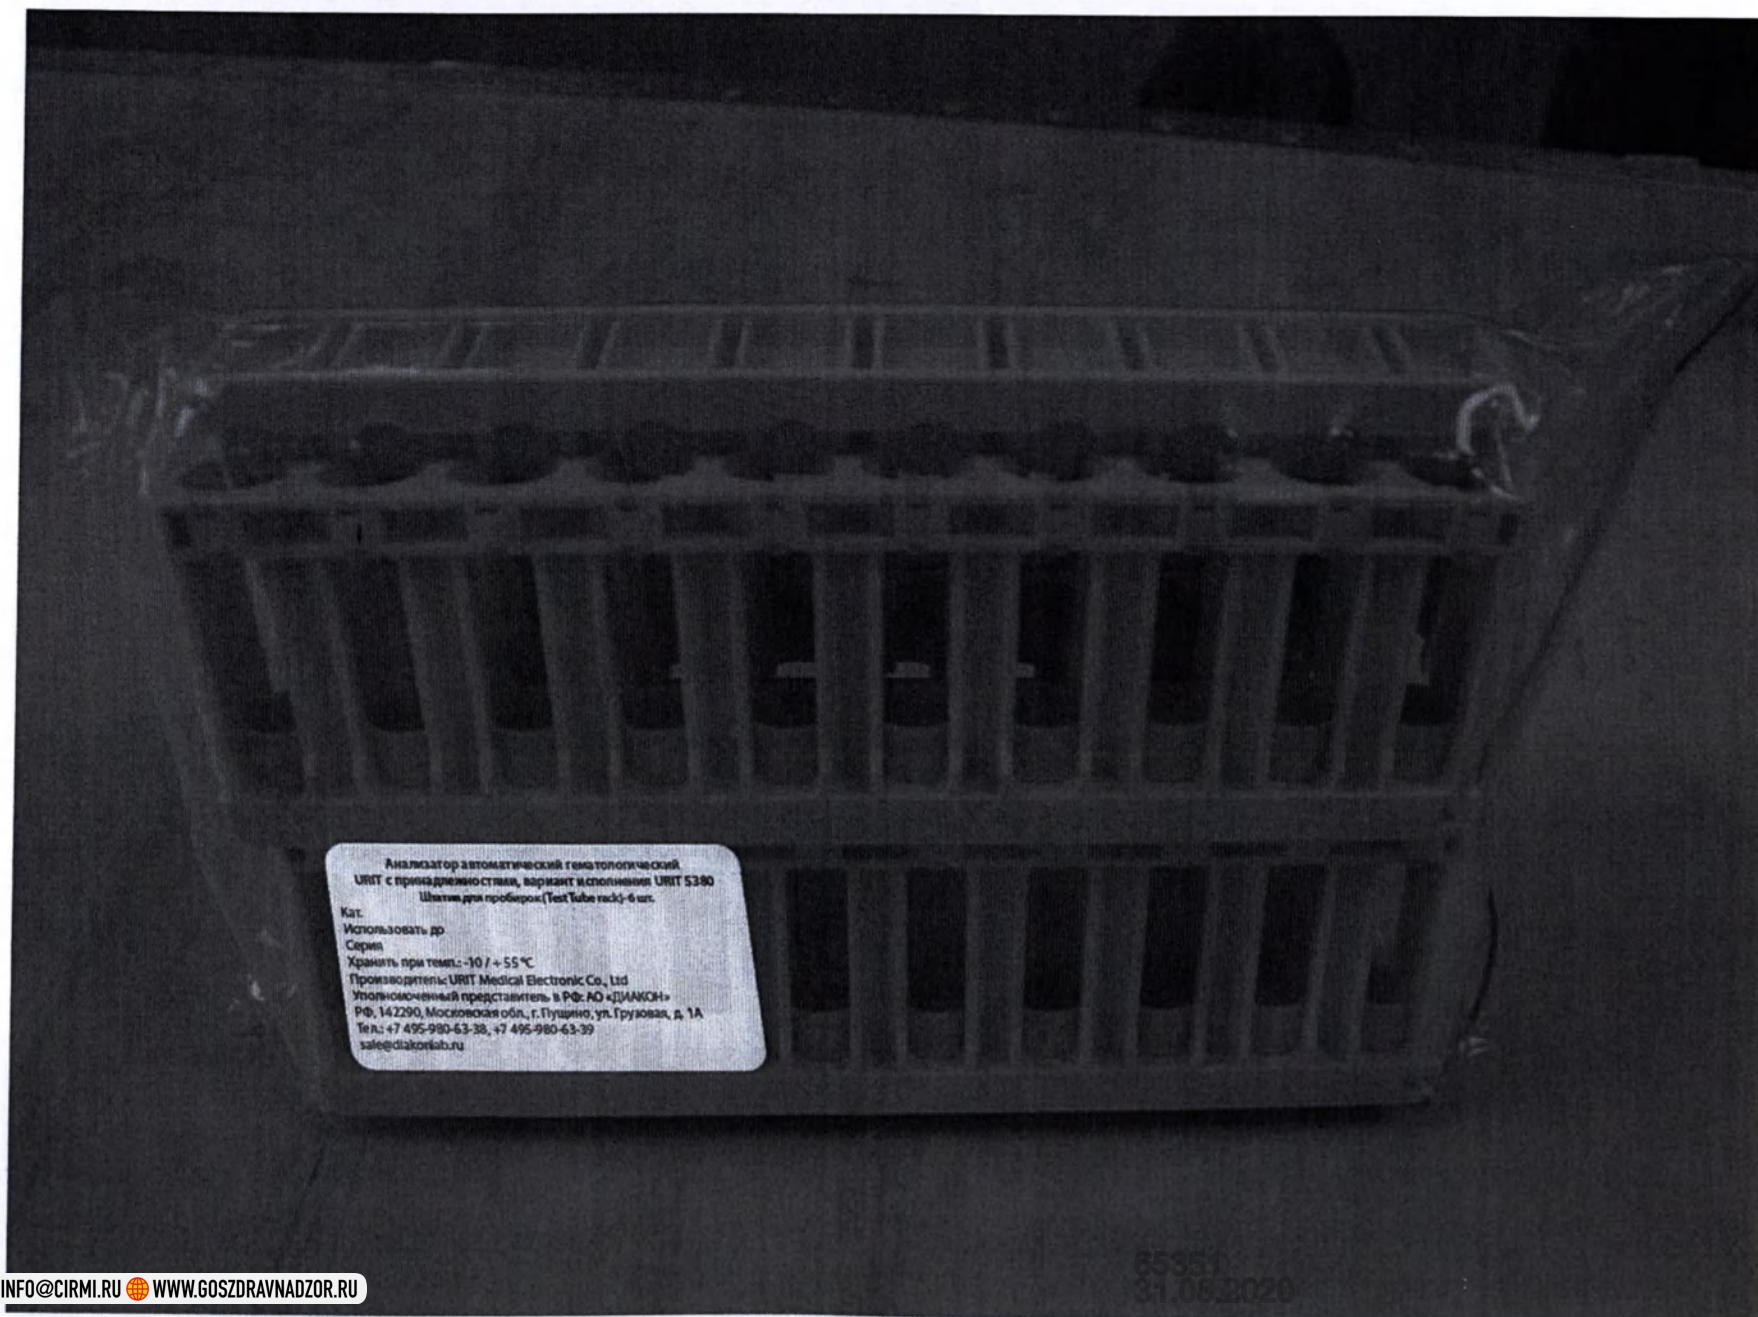

Анализатор автоматический гематологический  
URIT с принадлежностями, вариант исполнения URIT 5380  
Штатив для пробирок (Test Tube rack) - 6 шт.

Кат.

Использовать до

Серия

Хранить при темп.: -10 / +55 °C

Производитель: URIT Medical Electronic Co., Ltd


Уполномоченный представитель в РФ: АО «ДИАКОН»

РФ, 142290, Московская обл., г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1А

Тел.: +7 495-980-63-38, +7 495-980-63-39

sale@diakonlab.ru


18. Набор карточек идентификационных (Card set of product maintenance records).

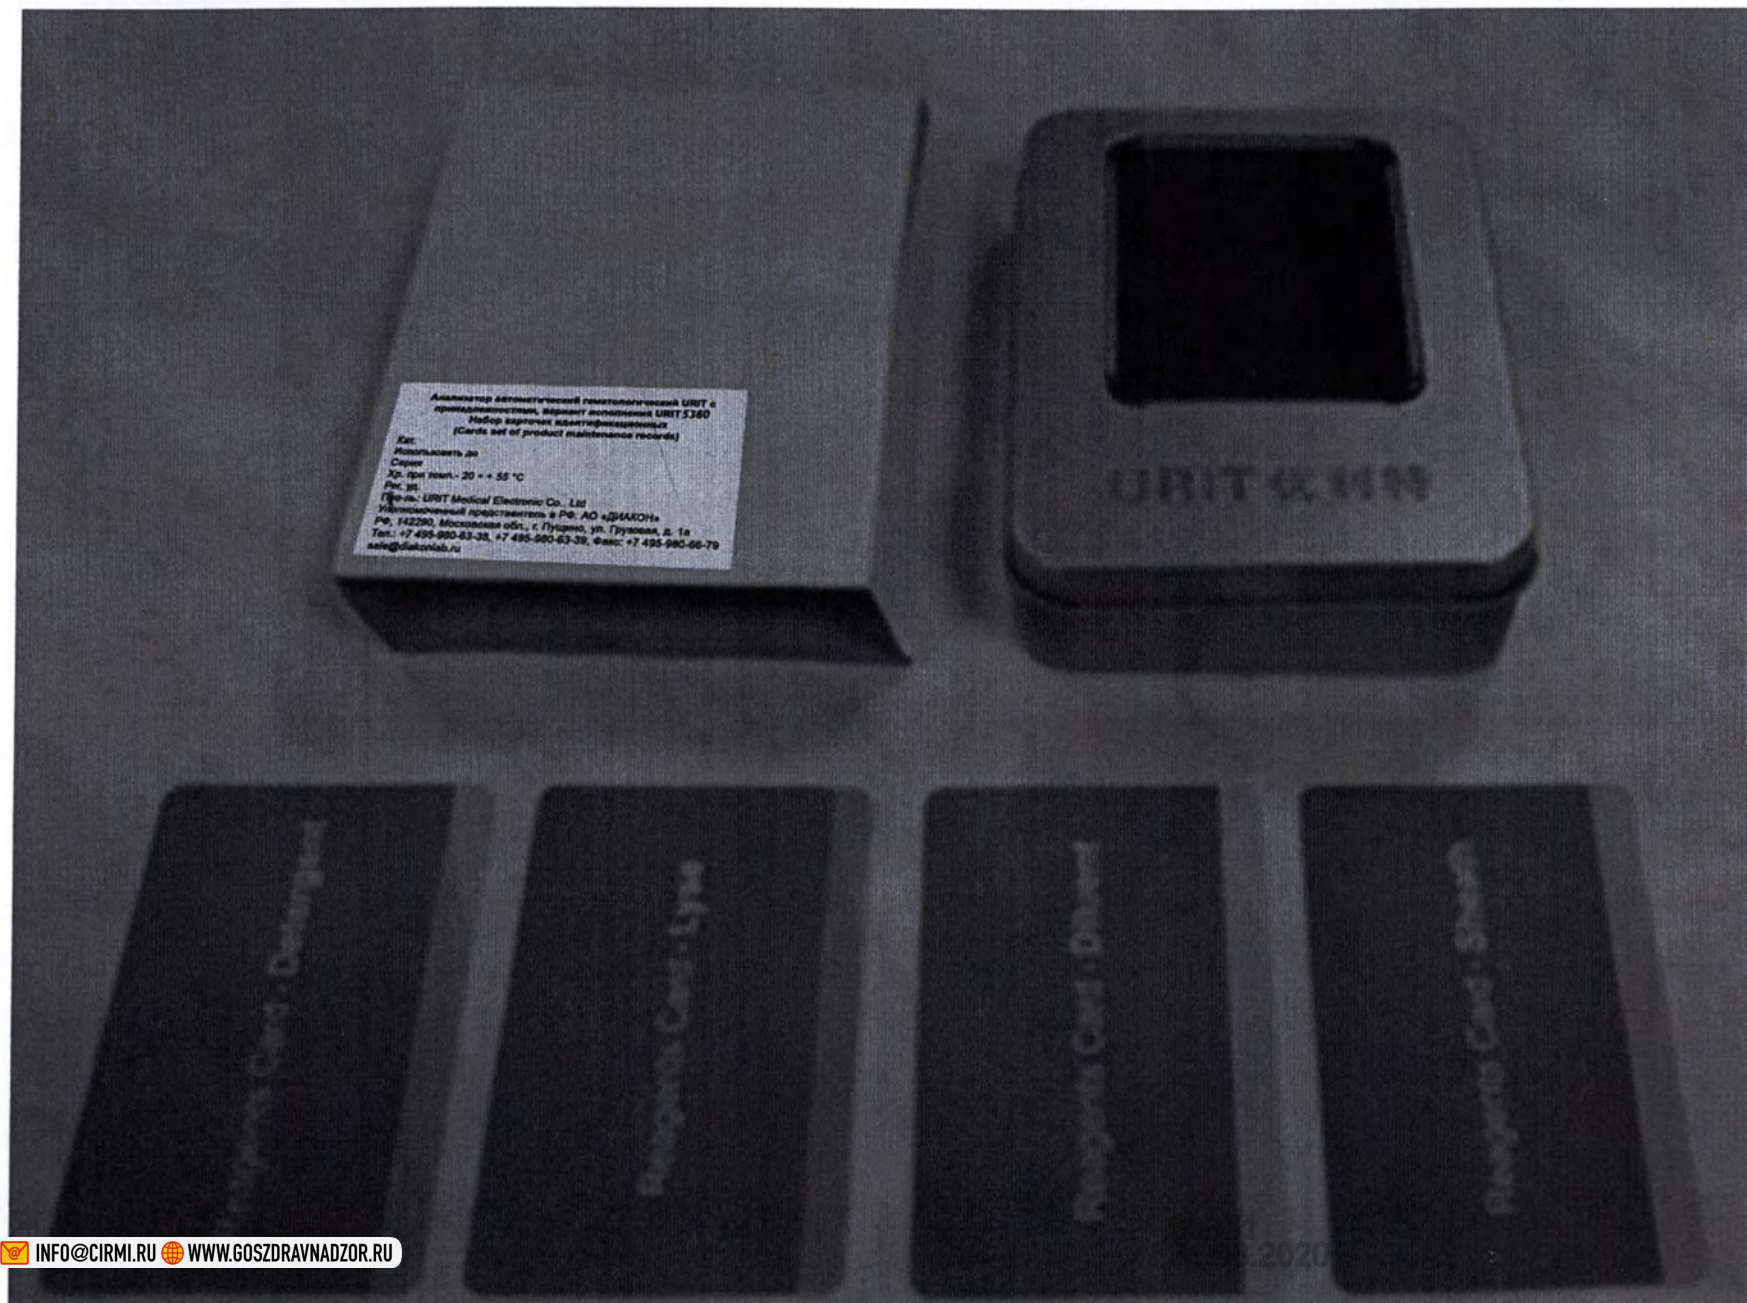


19. Сертификат квалифицированного продукта (Qualified Product Certificate).



20. Сертификат квалифицированного продукта (Qualified Product Certificate).

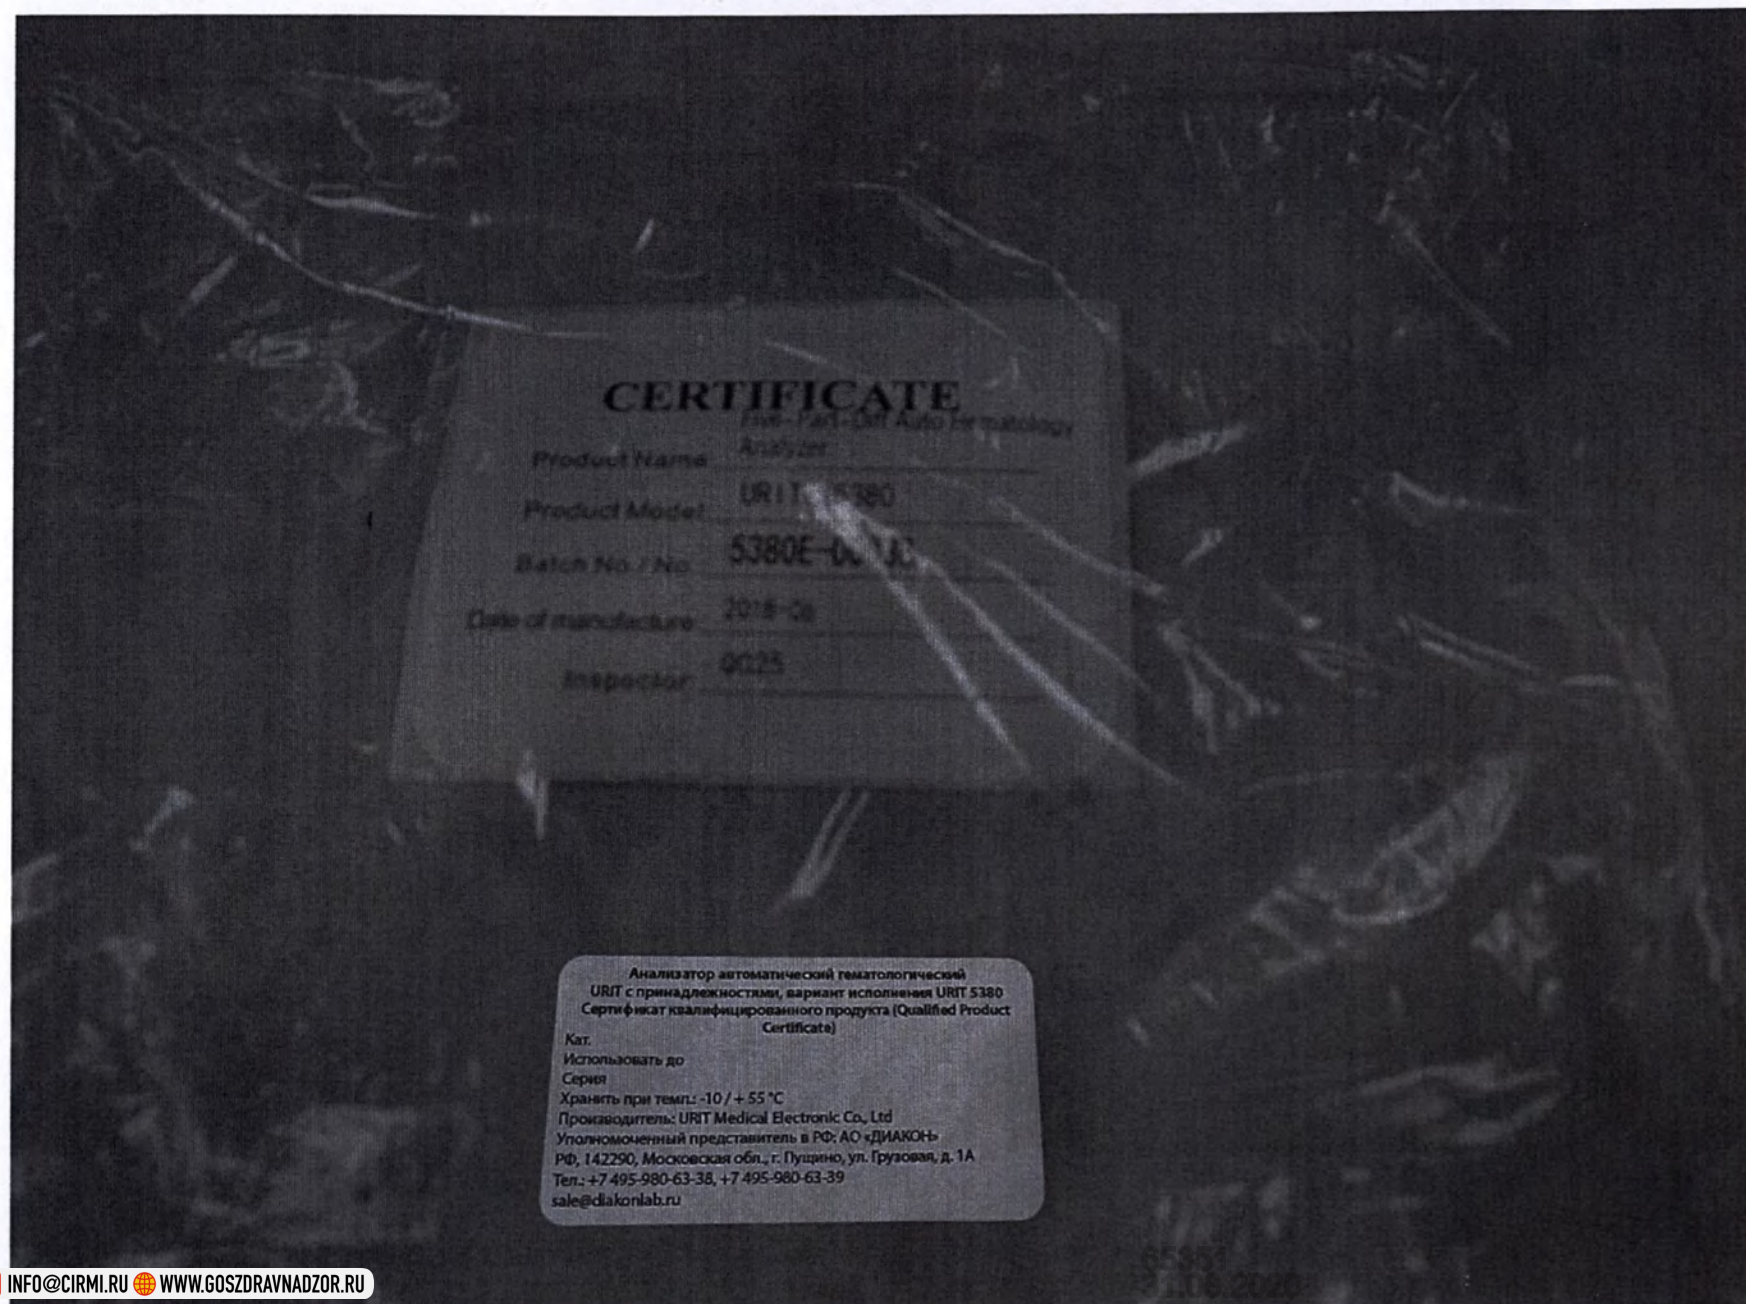

Генеральный директор  
АО «ДИАКОН»

 И.Е. Карпова

22 августа 2020 г.)

