

ПОДТВЕРЖДАЮ

Старший специалист по регистрации

медицинских изделий

Ю.Э. Потачина

2024 г.



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор для проведения факоэмульсификации и/или витрэктомии для системы офтальмологической микрохирургической Стелларис
Элит (Stellaris Elite), в вариантах исполнения

производитель Бауш энд Ломб Инкорпорейтед/ Bausch & Lomb Incorporated, США

2024 г.

1. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25 ga. Общий вид.



2. Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 27 ga. Общий вид.




3. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23 ga. Общий вид.



4. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25 ga. Общий вид.



5. Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 27 ga. Общий вид.

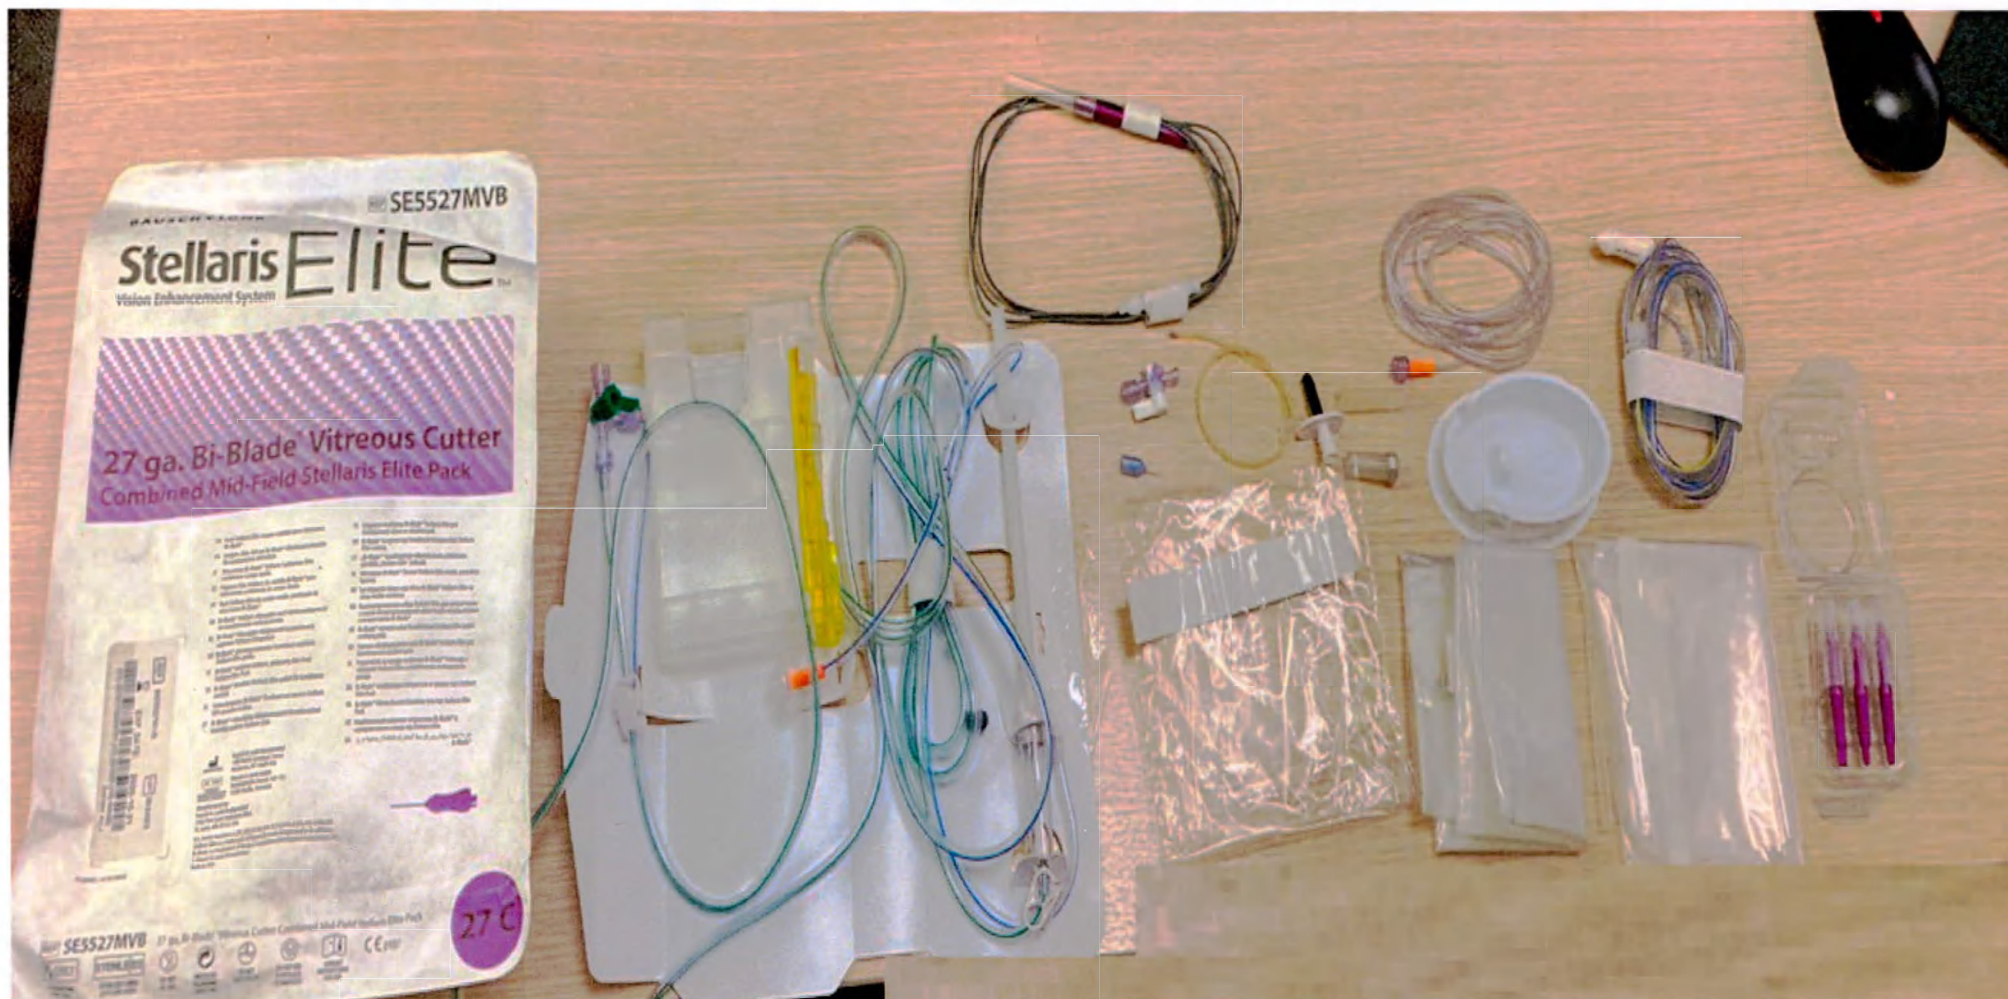

6. Набор для бесшовной витректомии 25 ga. Общий вид.



7. Набор Adaptive Fluidics Premium для микроинвазивной фактозмулясификации. Общий вид.




8. Набор Adaptive Fluidics Standard для микроинвазивной фактоэмульсификации. Общий вид.




9. Набор Adaptive Fluidics Basic для микроинвазивной факозмульсификации. Общий вид.



10. Кассета и ирригационно-аспирационная система с принудительной инфузией АФИ в сборе с зажимом, фильтром, двухходовым краником и капельницей

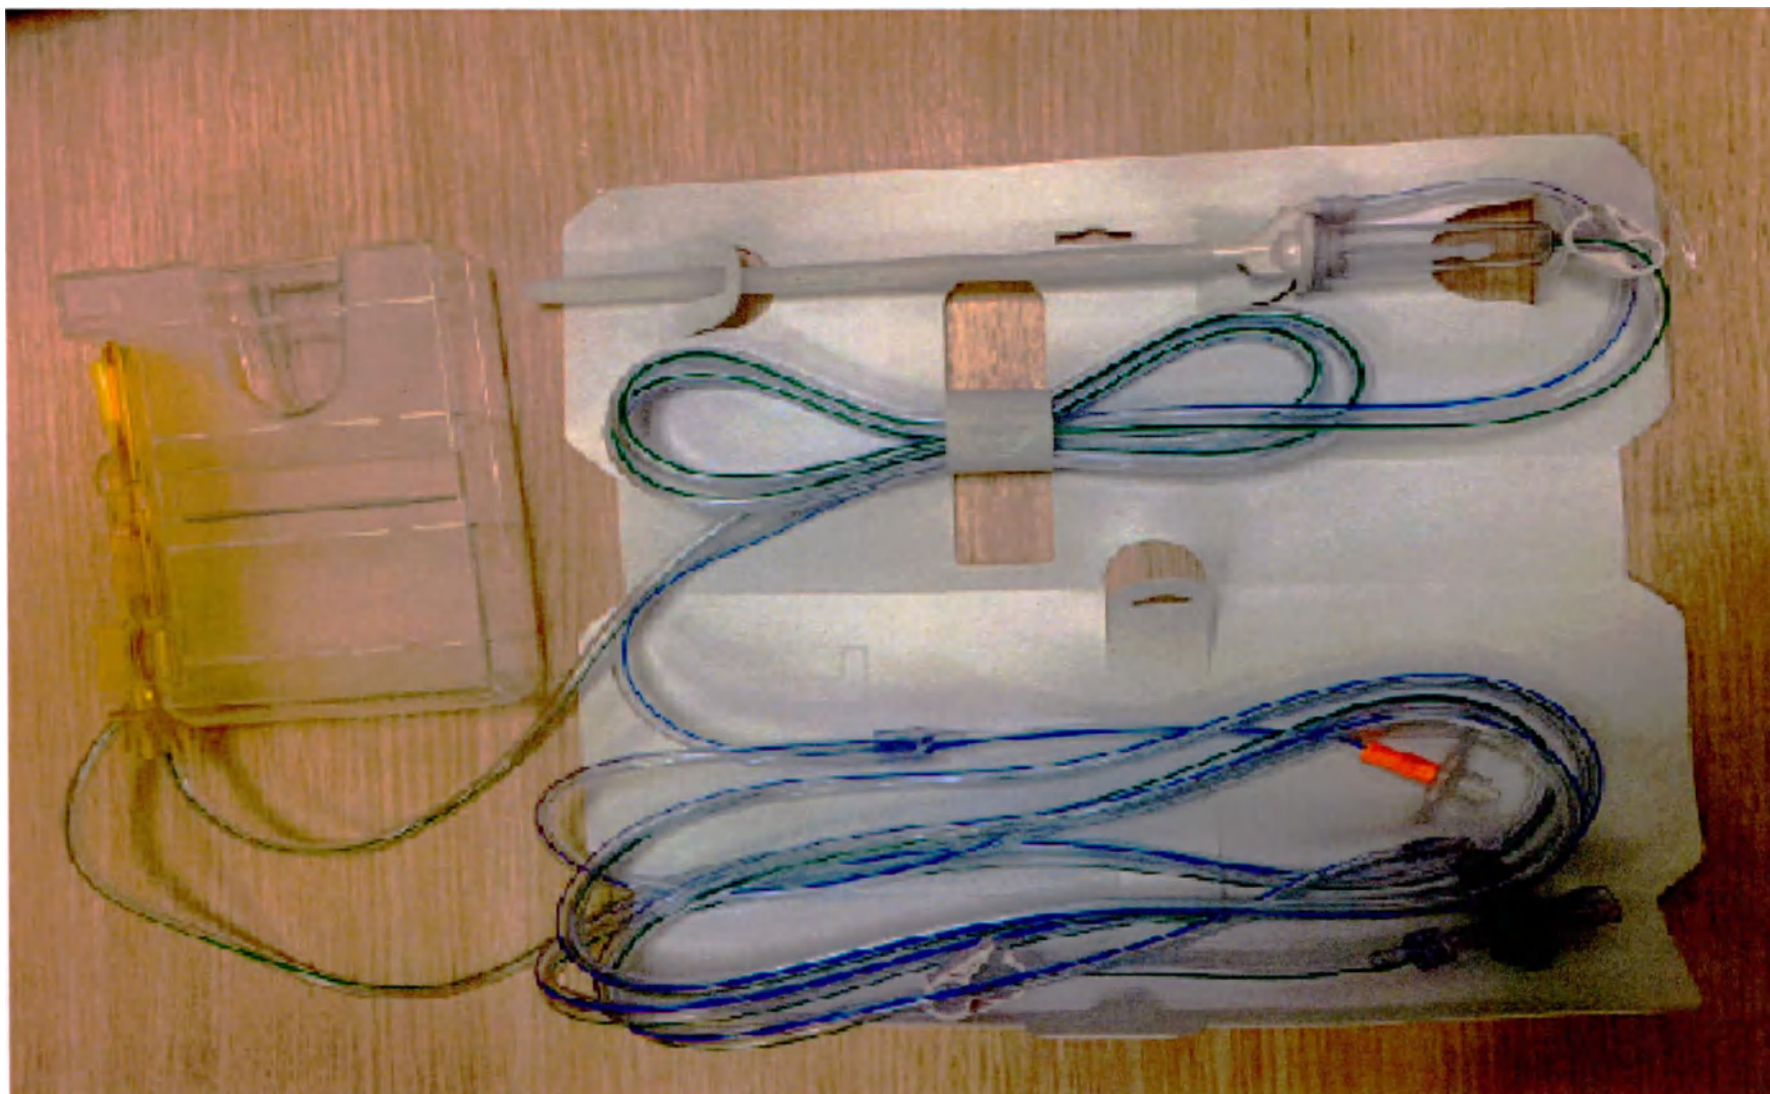

11. Кассета и ирригационно-аспирационная система в сборе с фильтром, соединителем Люэра и зажимом.

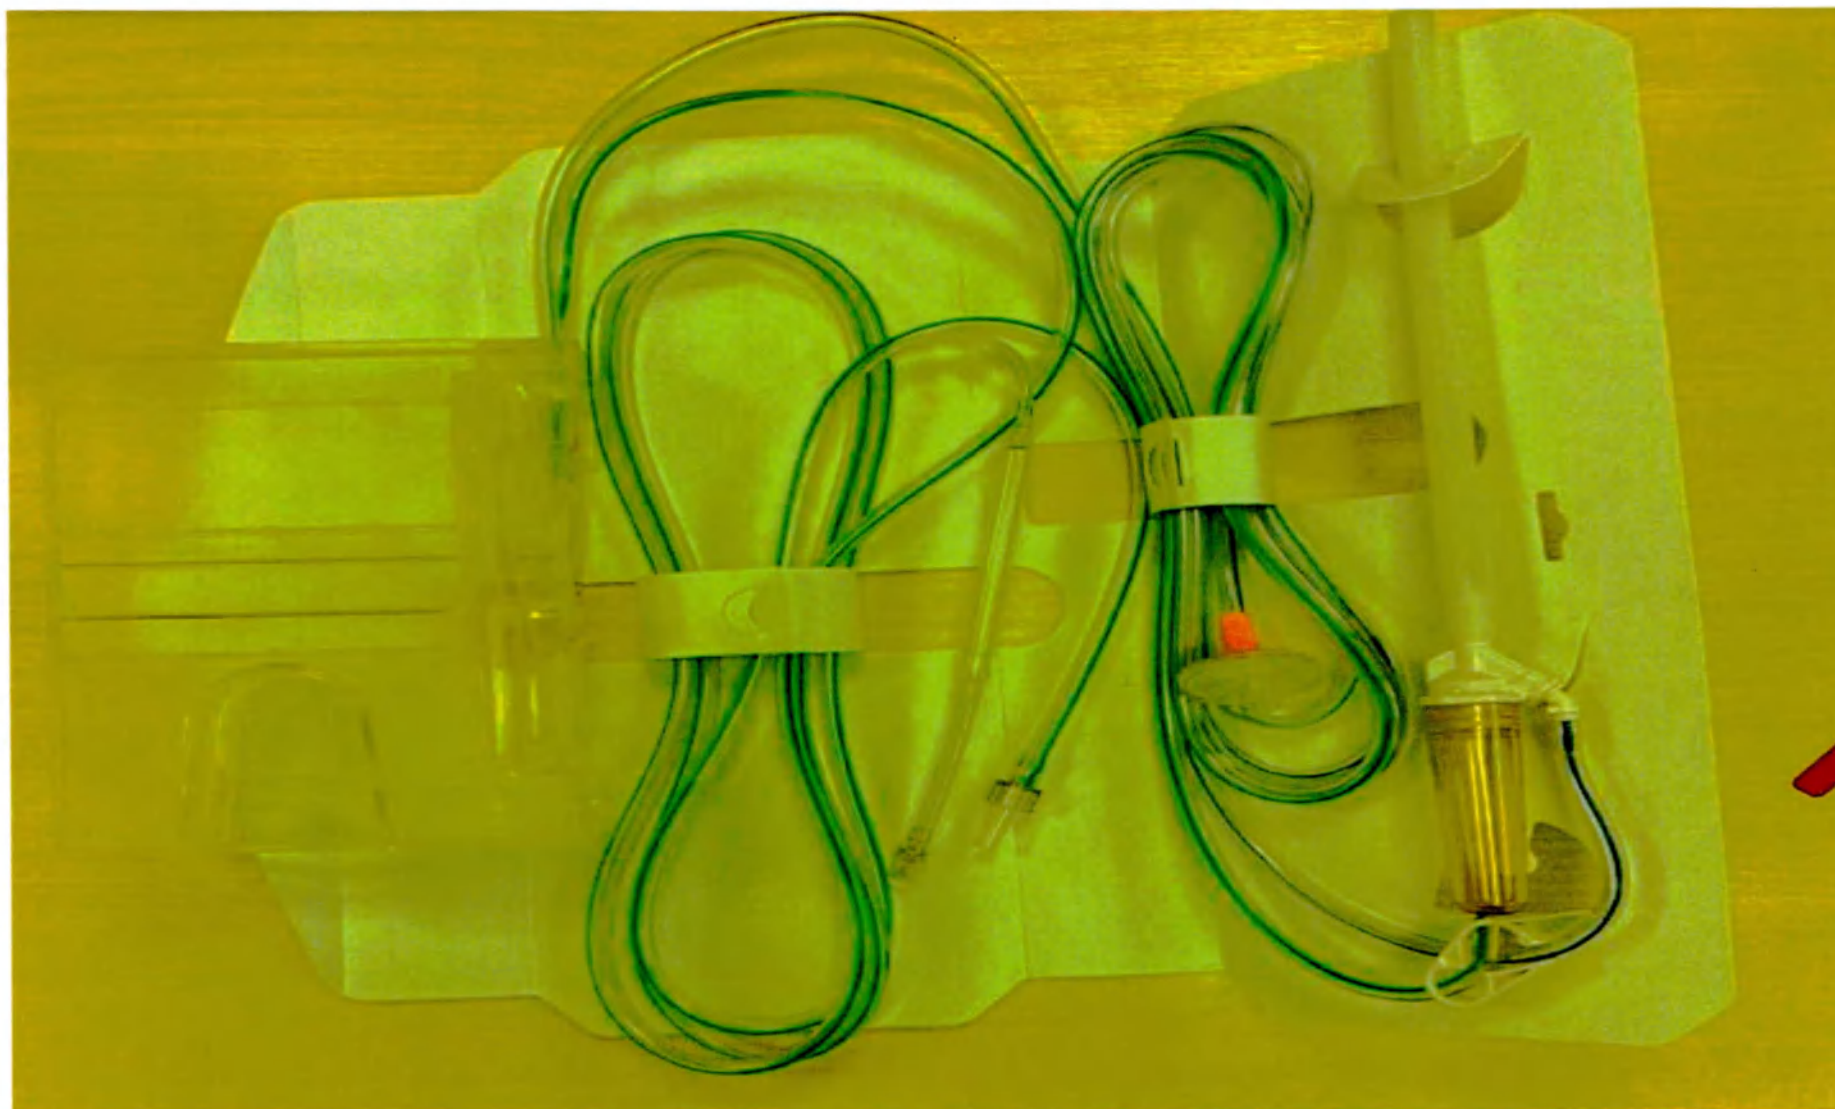


12. Ключ для фиксации игл фактоэмulsionфикации, с металлическим наконечником -1 шт.



13. Линия аспирационная, левая, с разъемами Люэра, 214 см – 1 шт.;




14. Канюля инфузионная с коннектором Люэра, 30 см, зеленая – 1 шт.;

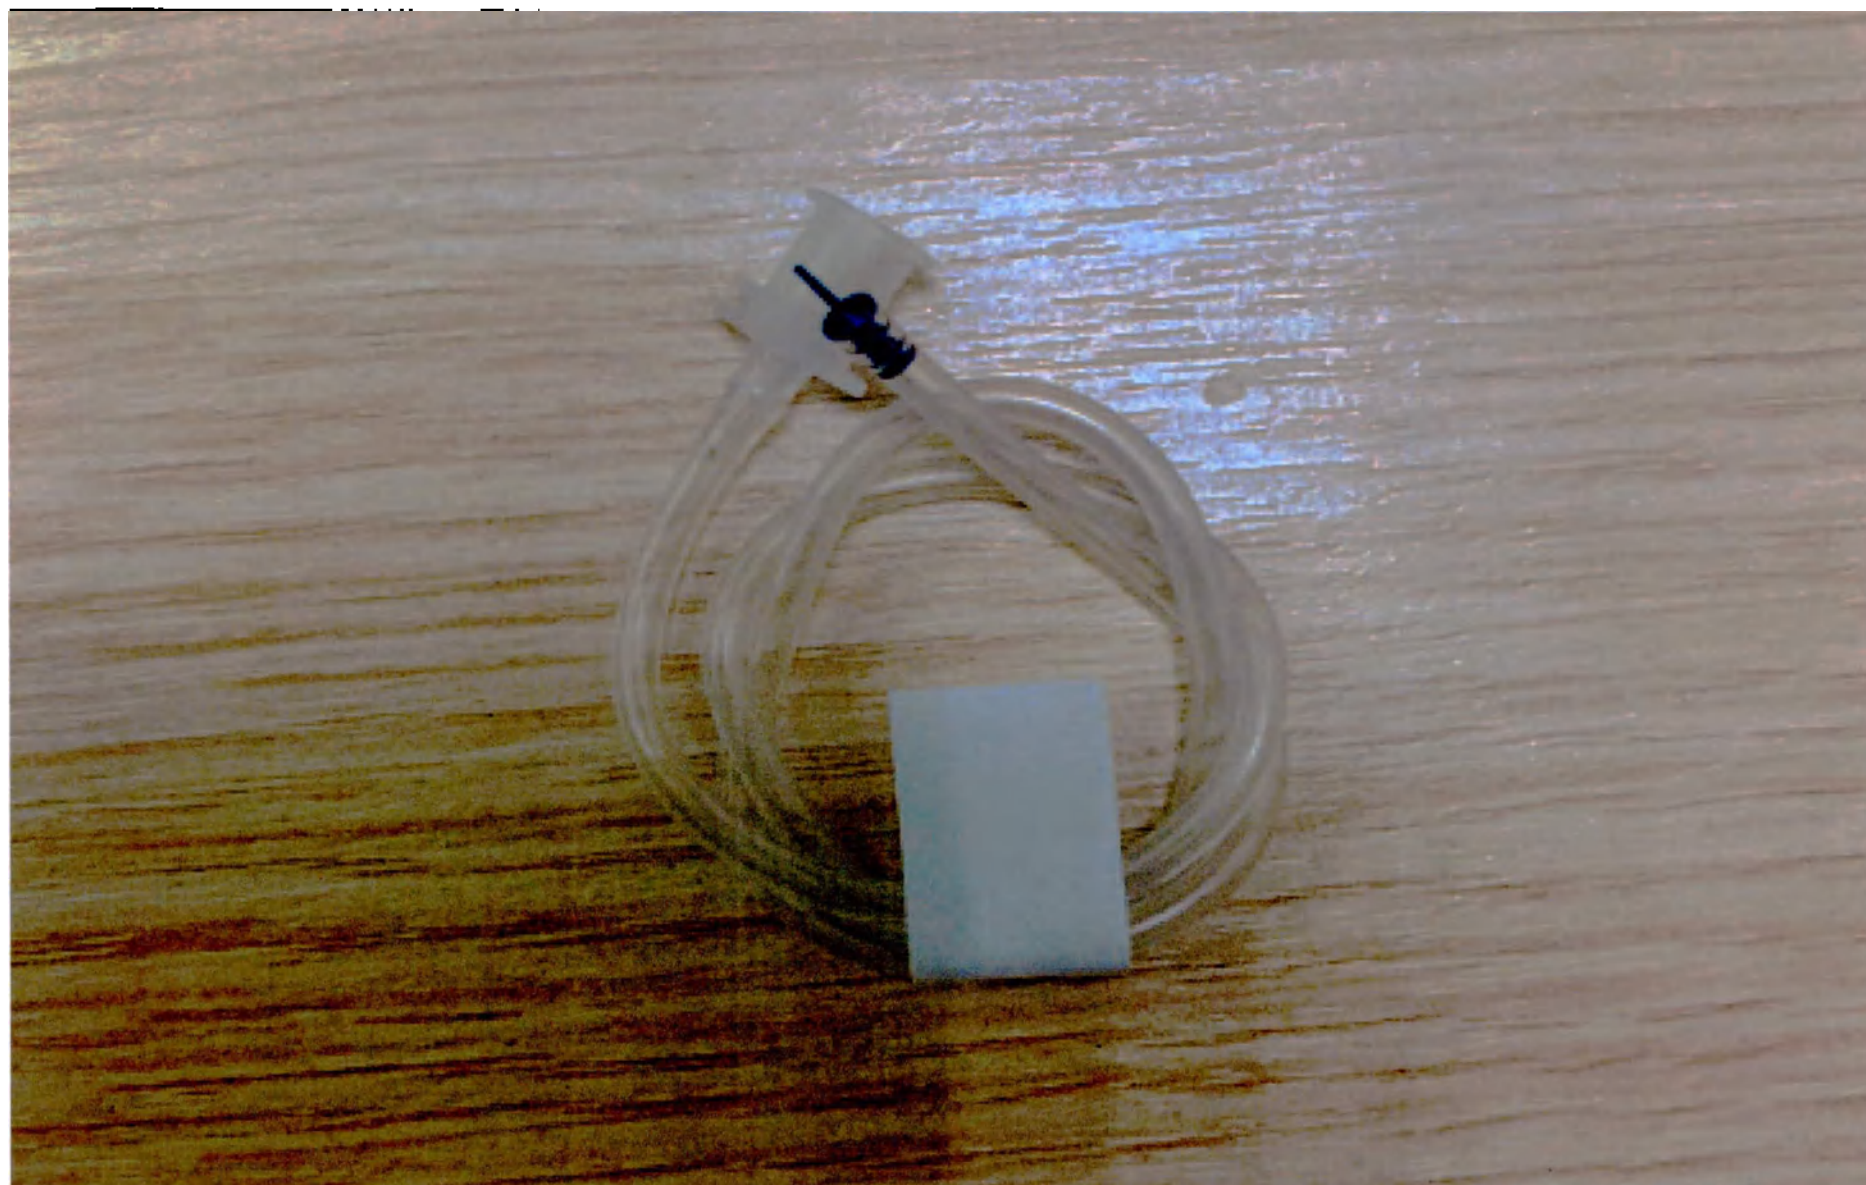

15. Чехол для экрана Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;



16. Чехол для пульта дистанционного управления Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт

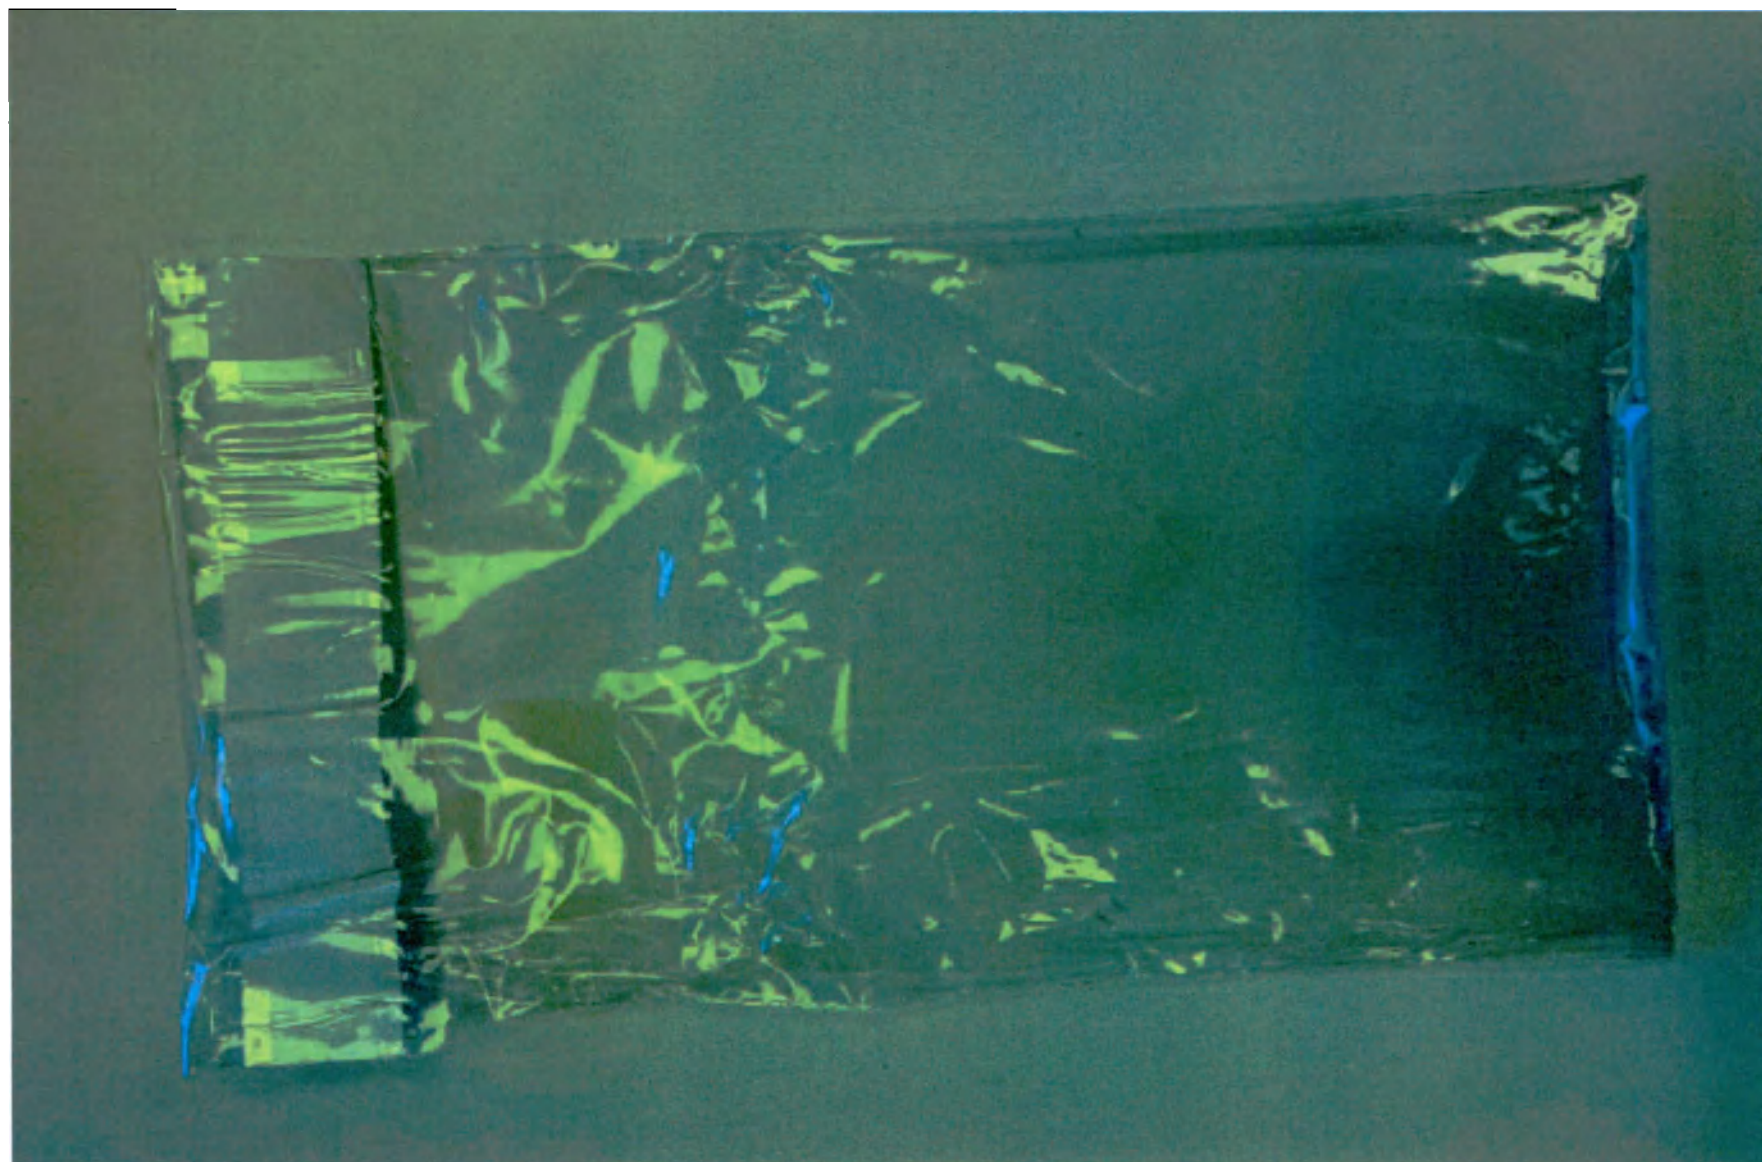

17. Чехол для лотка Майо Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.



18. заглушка для закрытия отверстия на кассете – 1 шт.




19. Тест-камера для тестирования ультразвуковой рукоятки к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite) – 1 шт.



20. Лоток для тестирования пневматического ножа – 1 шт.;



21. Соединитель Люэра – 1 шт.

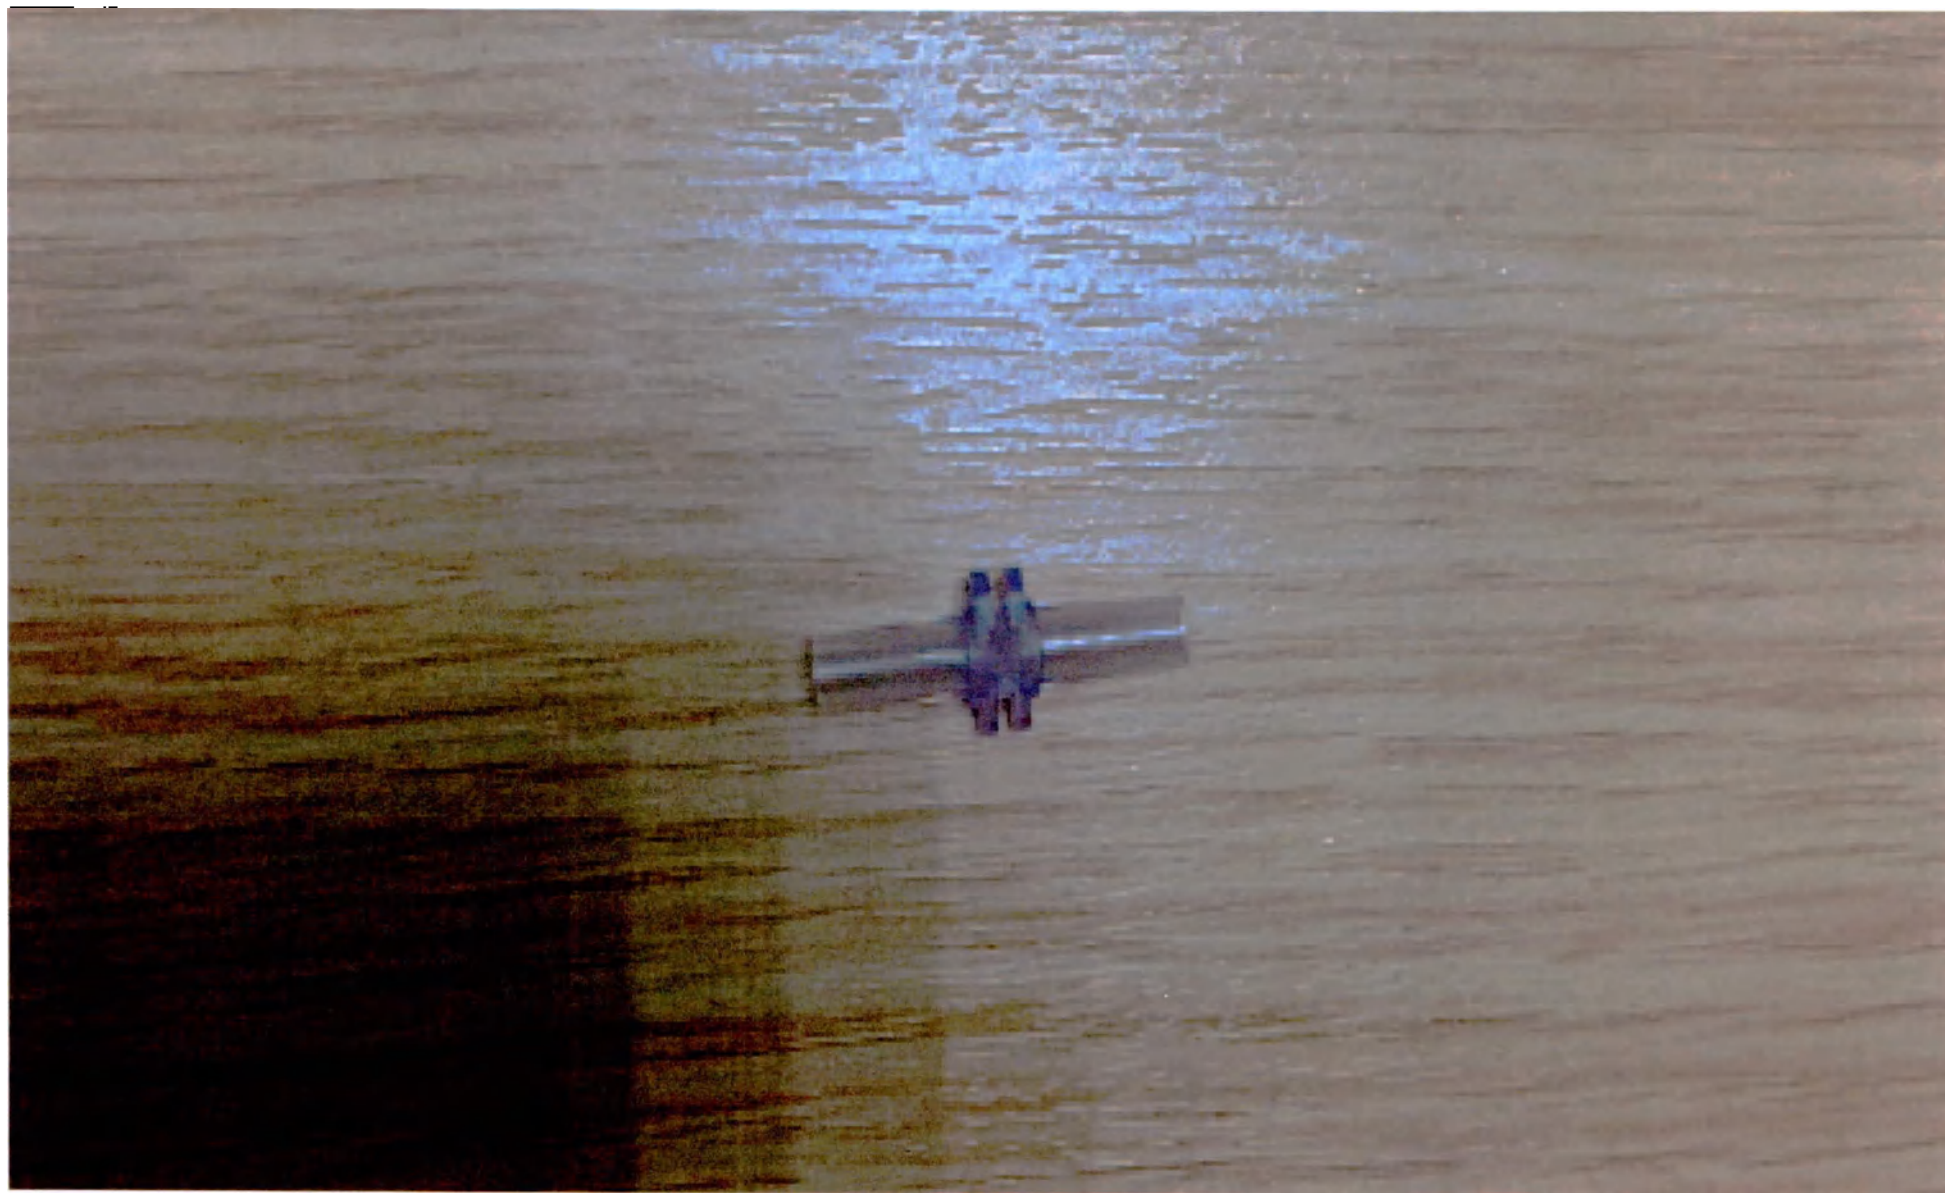

22. Слив ирригационный для иглы факэмульсификации , с внутренней резьбой для ультразвуковой рукоятки к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite) (для разреза 1,8 мм) – не более 2 шт.;




23. Слив ирригационный для иглы факозмульсификации, с внутренней резьбой для ультразвуковой рукоятки к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite) (для разреза 2,4 мм) – 2 шт.




24. Прокалывать бутылки – 1 шт.;




25. Пневматический нож 23 га – 1 шт.;

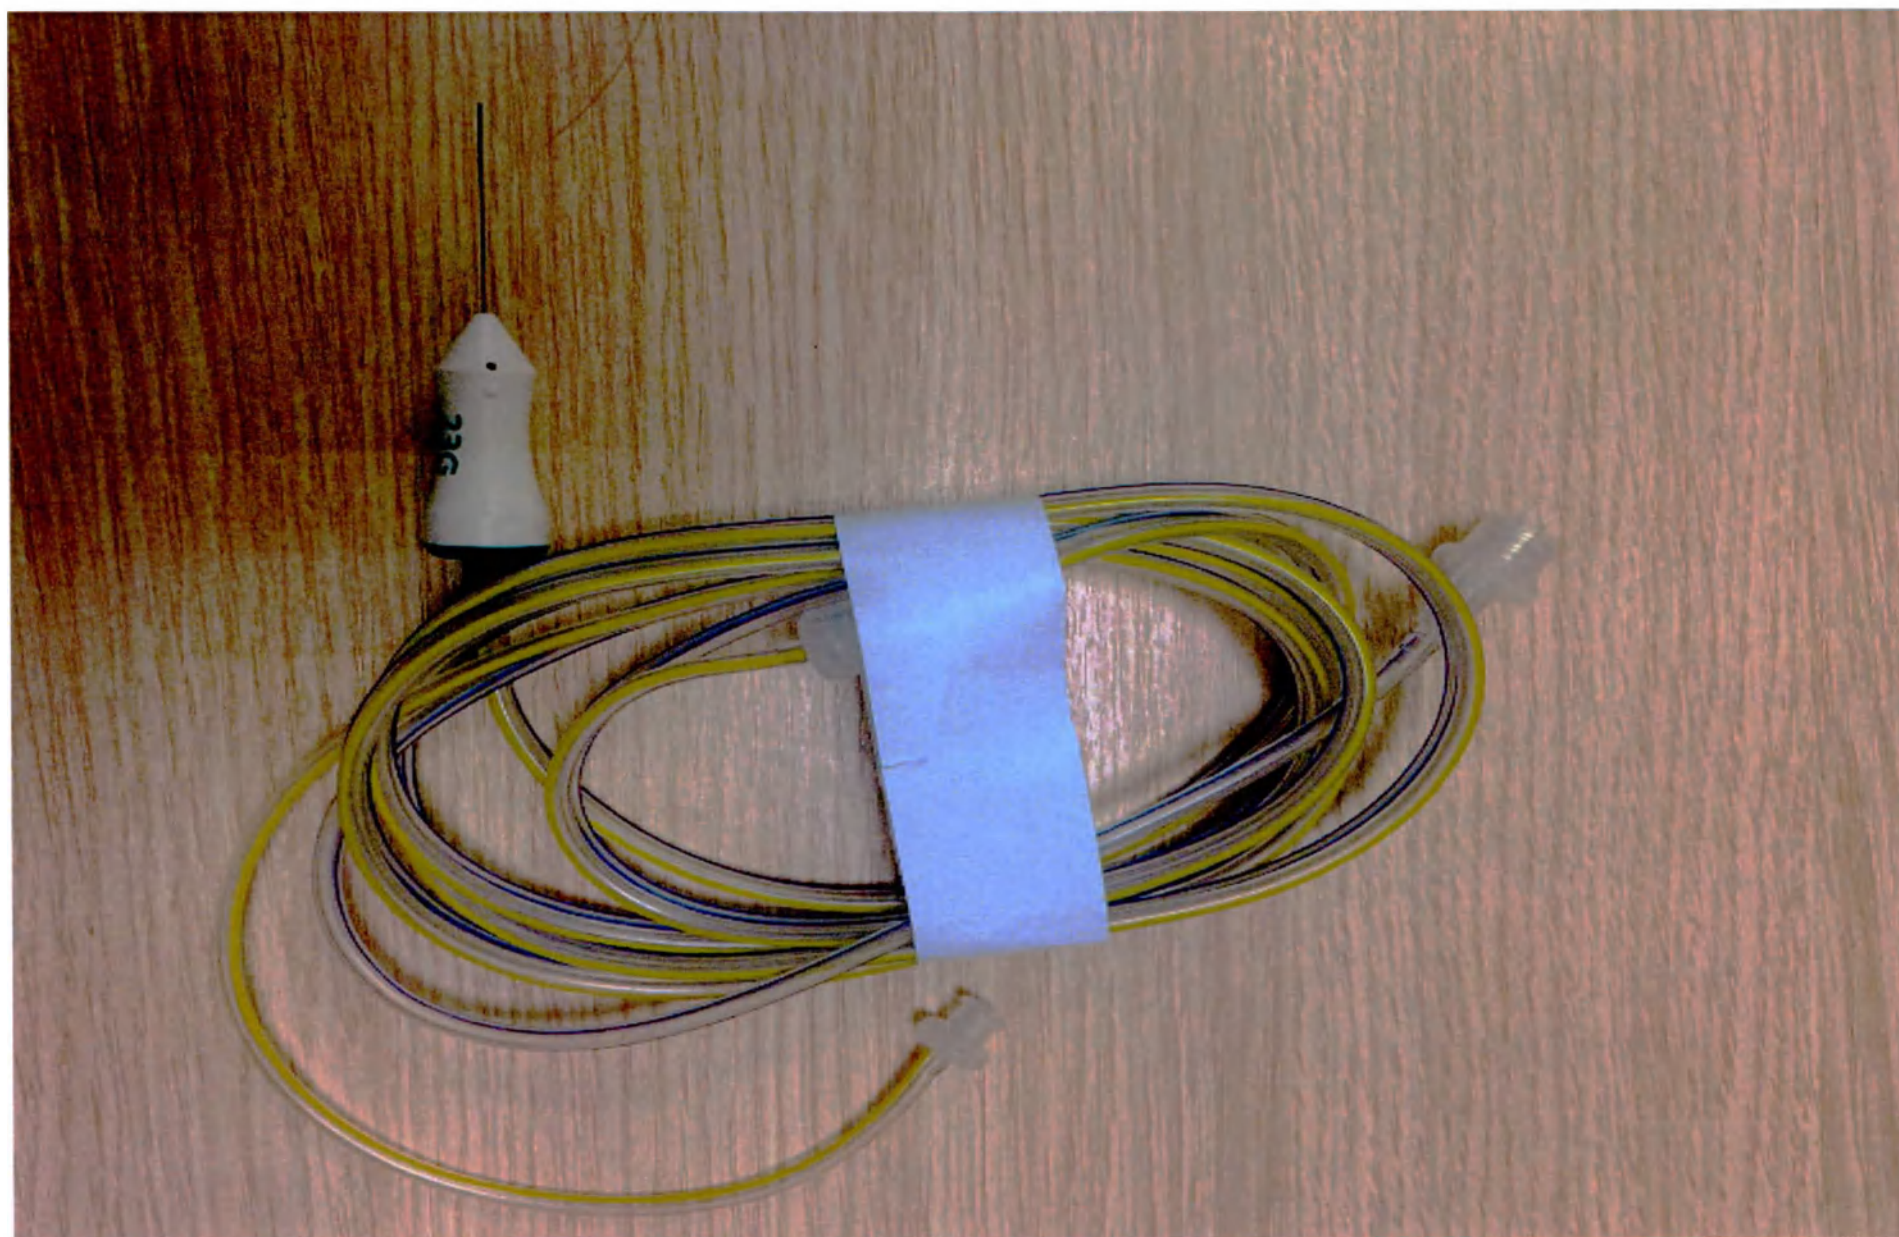


26. Пневматический нож bi-Blade® – 1 шт.

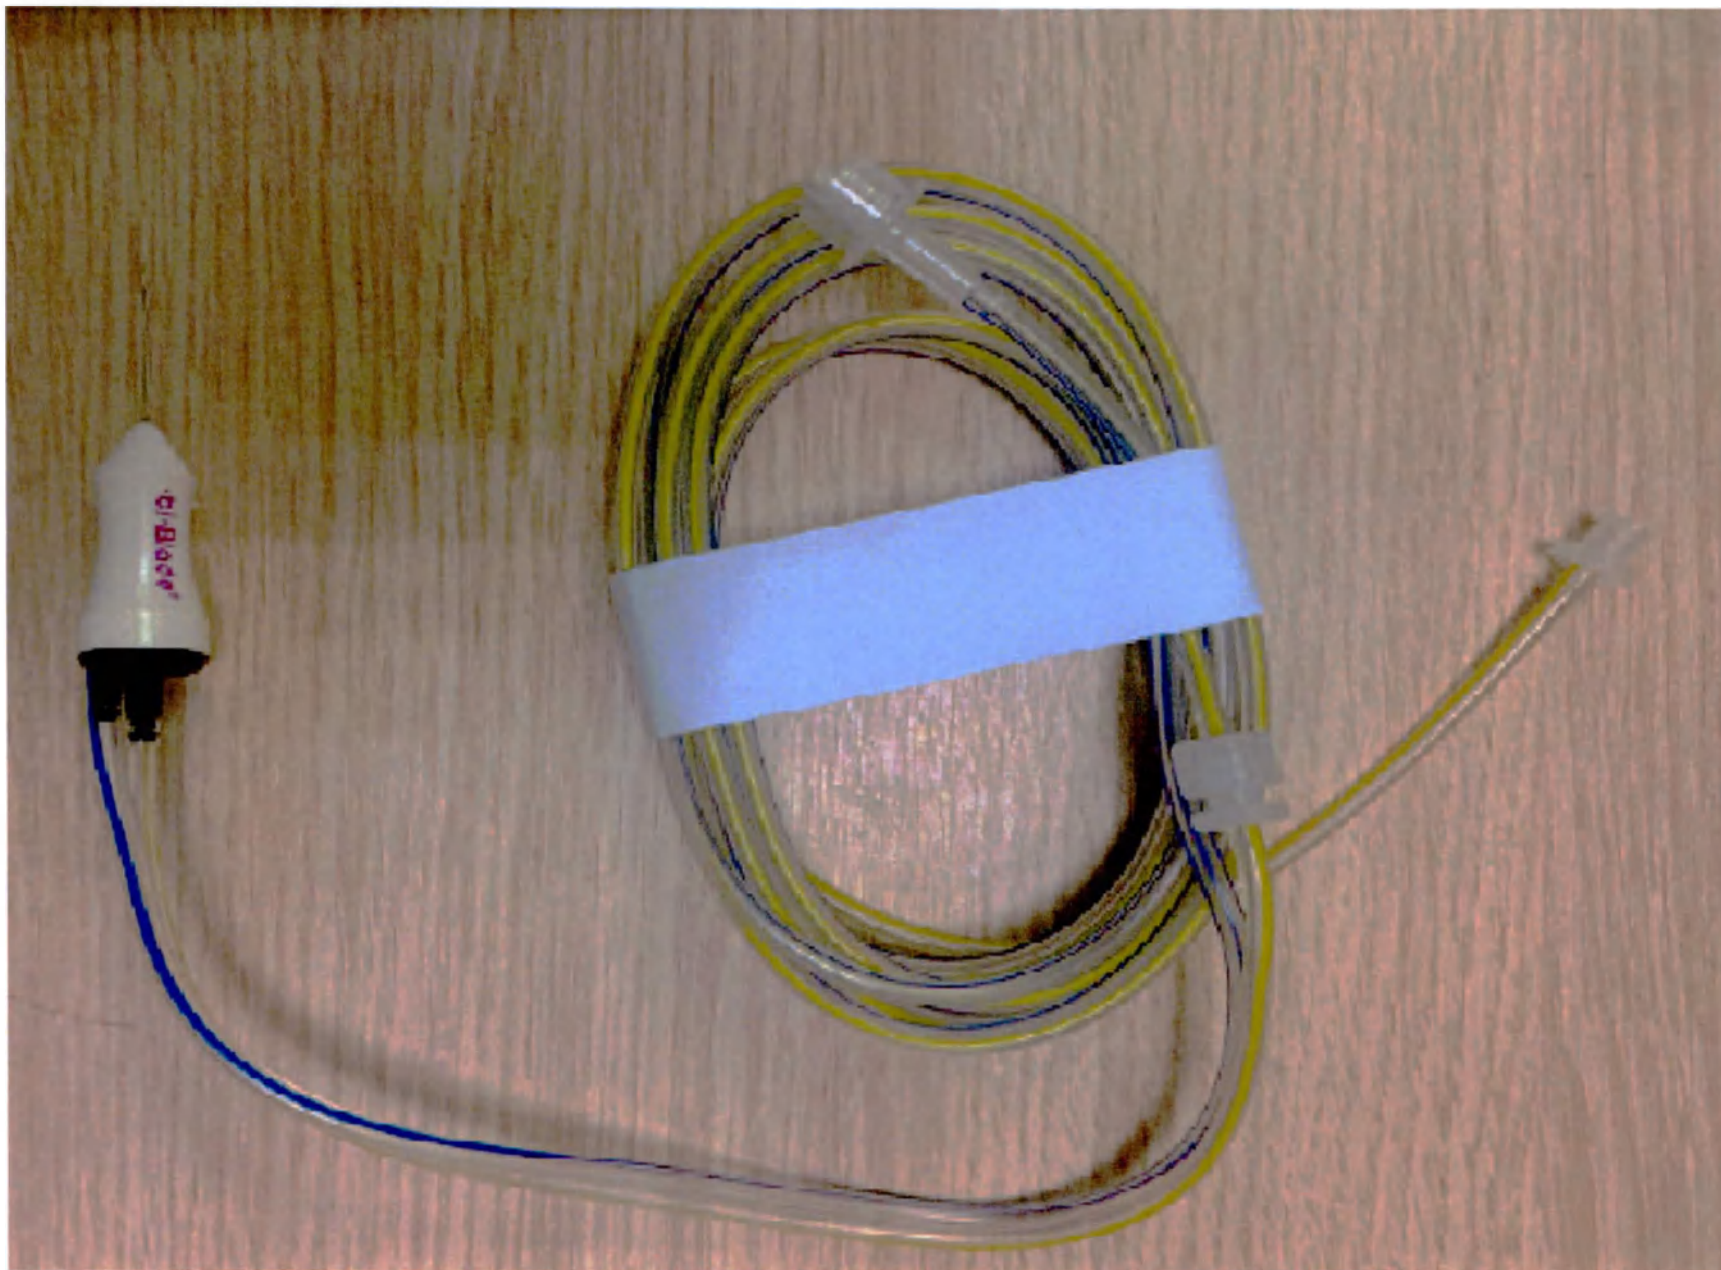

27. Держатель со склеральными заглушками (3 шт.) – 1 шт. ;

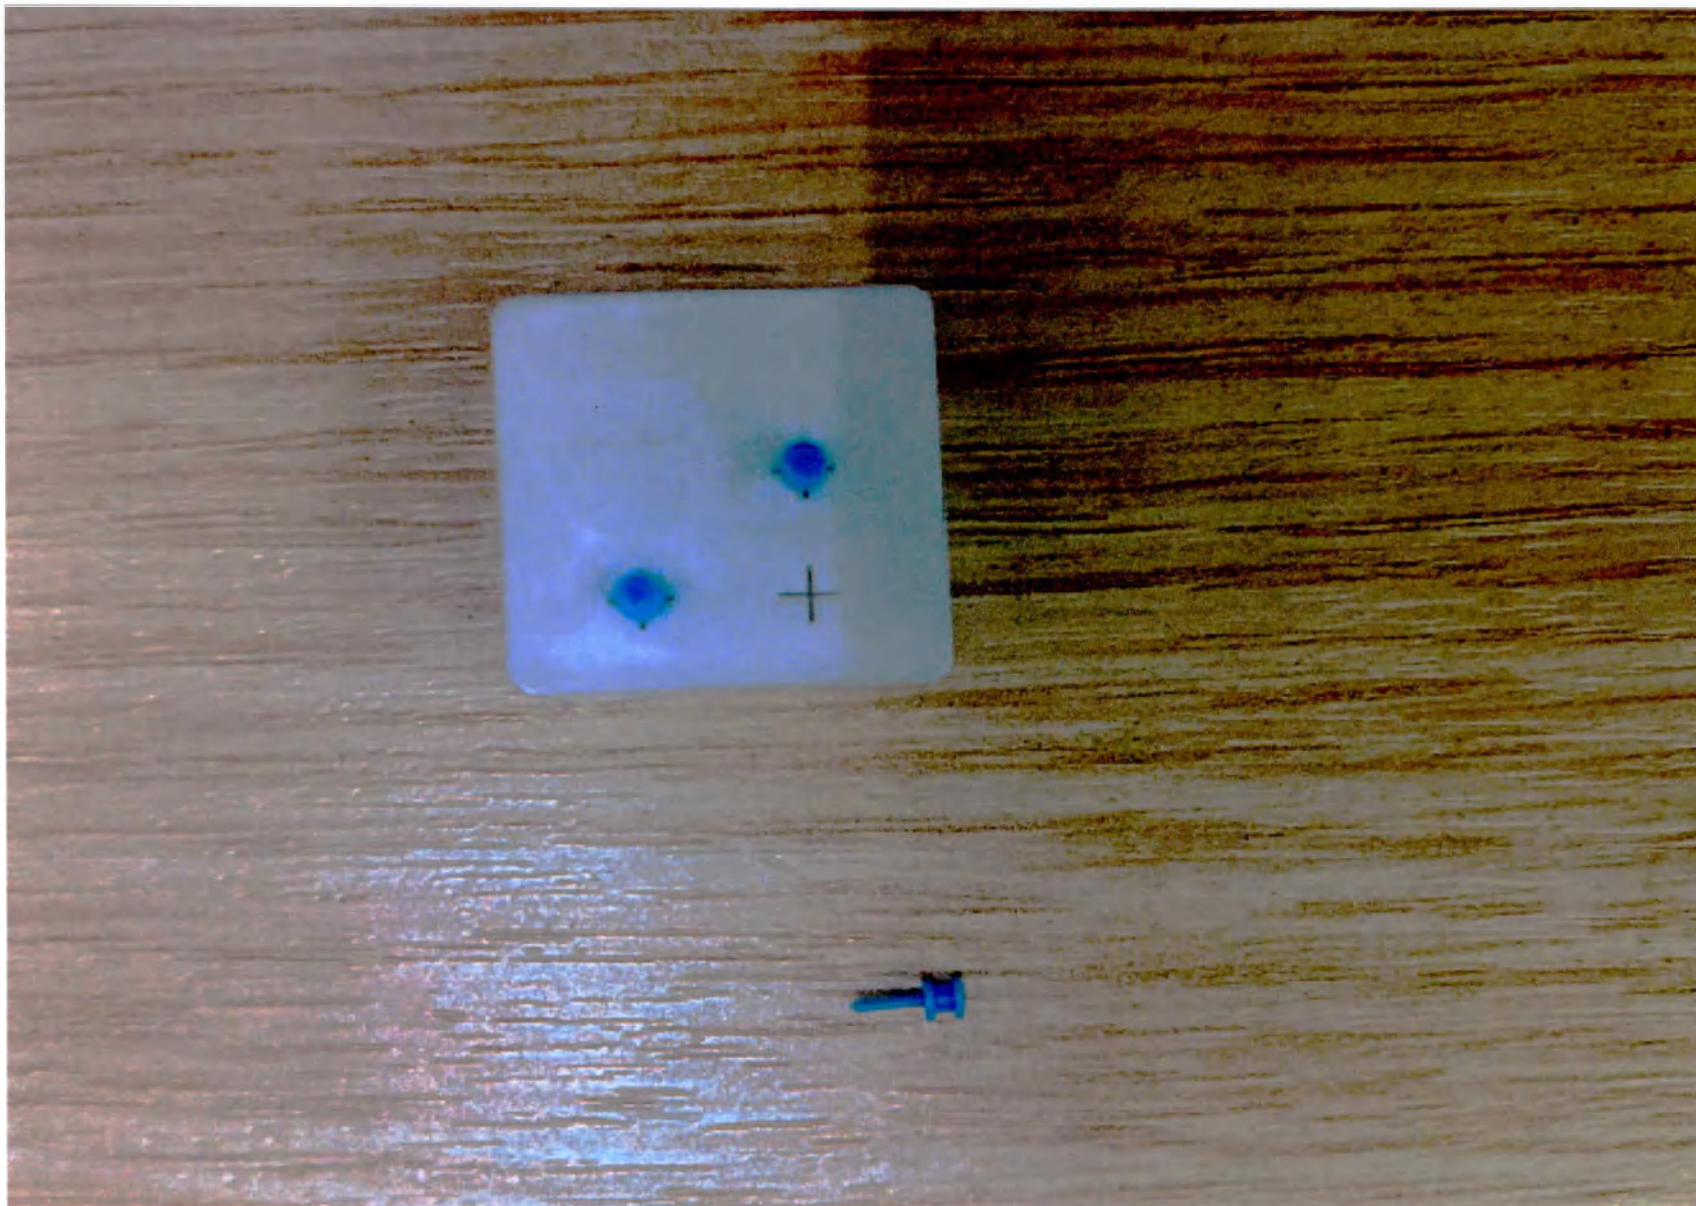

28. Эндоосветитель 23 га с портом для подсоединения к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite),зеленый, 219 см – 1 шт.;

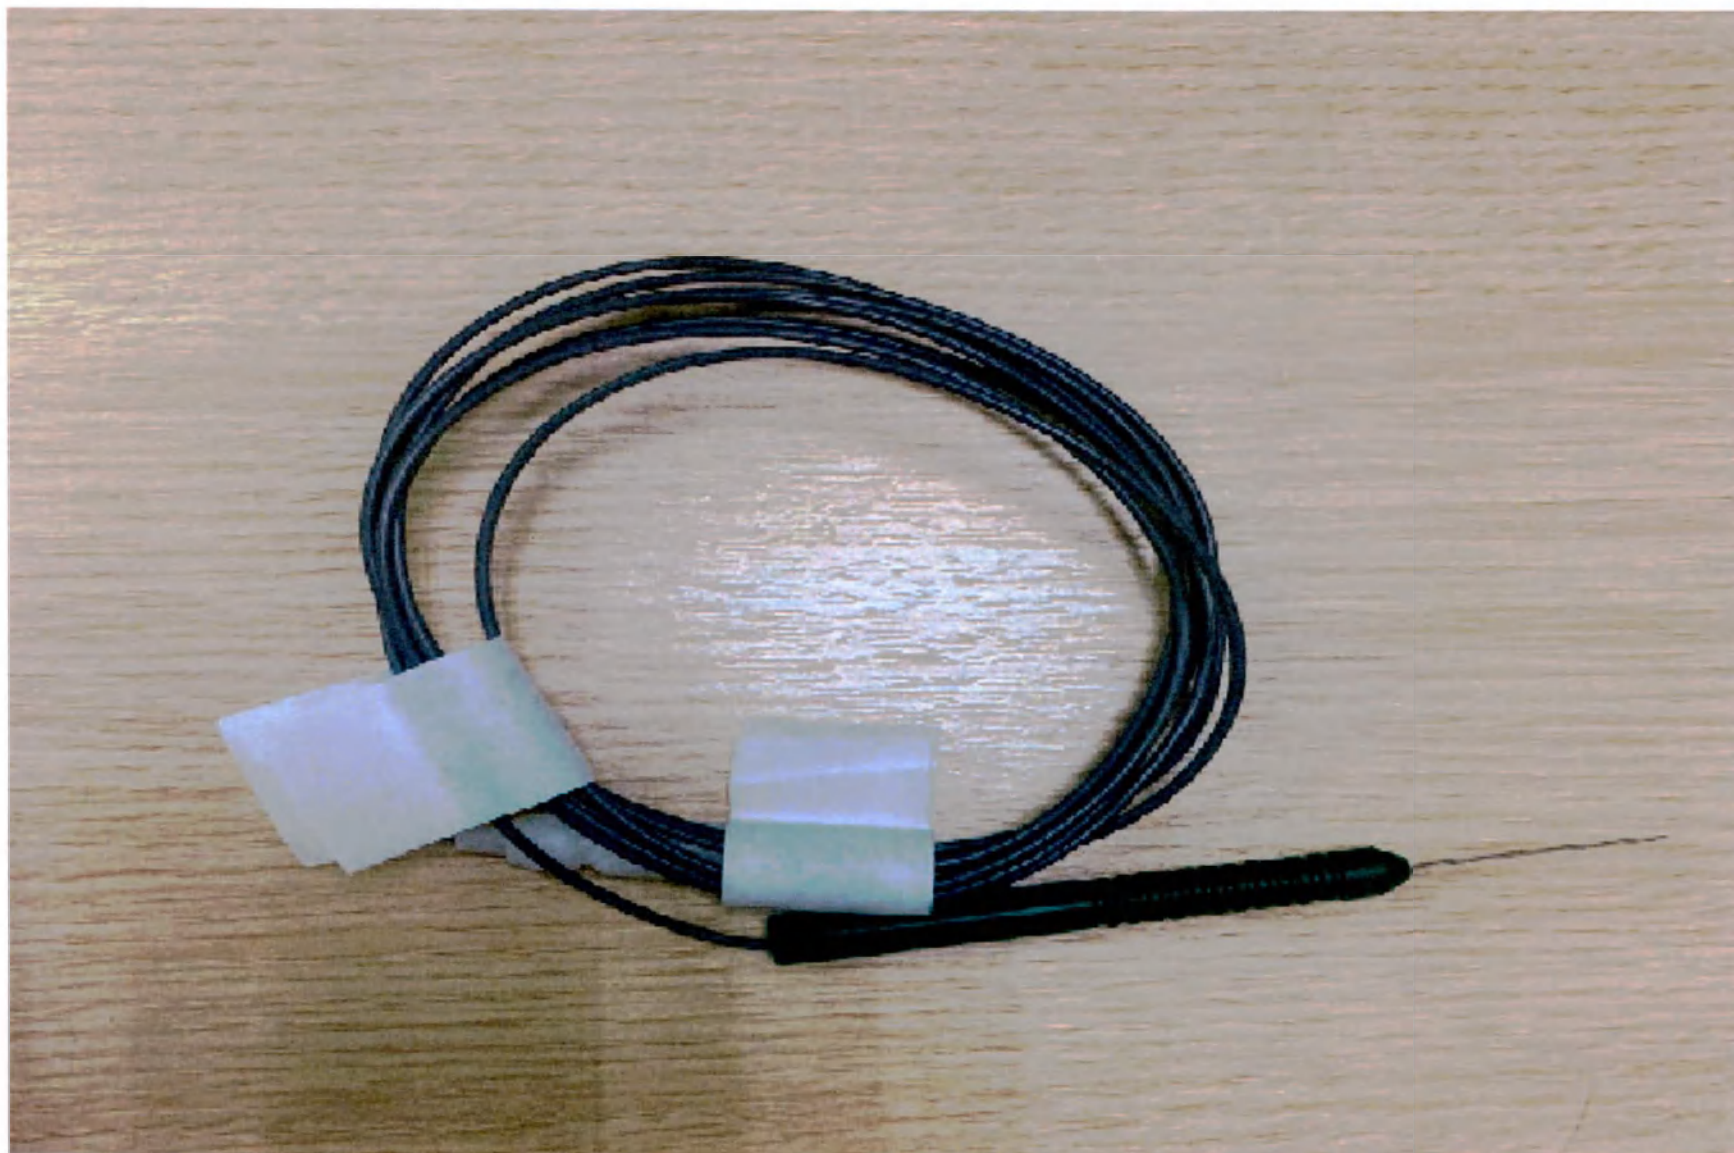


29. Троакар (нож типа ланцет с рукояткой и порт с клапаном) с колпачком в сборе 23 ga, зеленый – 3 шт.;



30. краник трехходовой, с соединителем Люэра – 1 шт.;



31. Ключ для фиксации игл фактоэмульсификации, с металлическим наконечником – 1 шт.

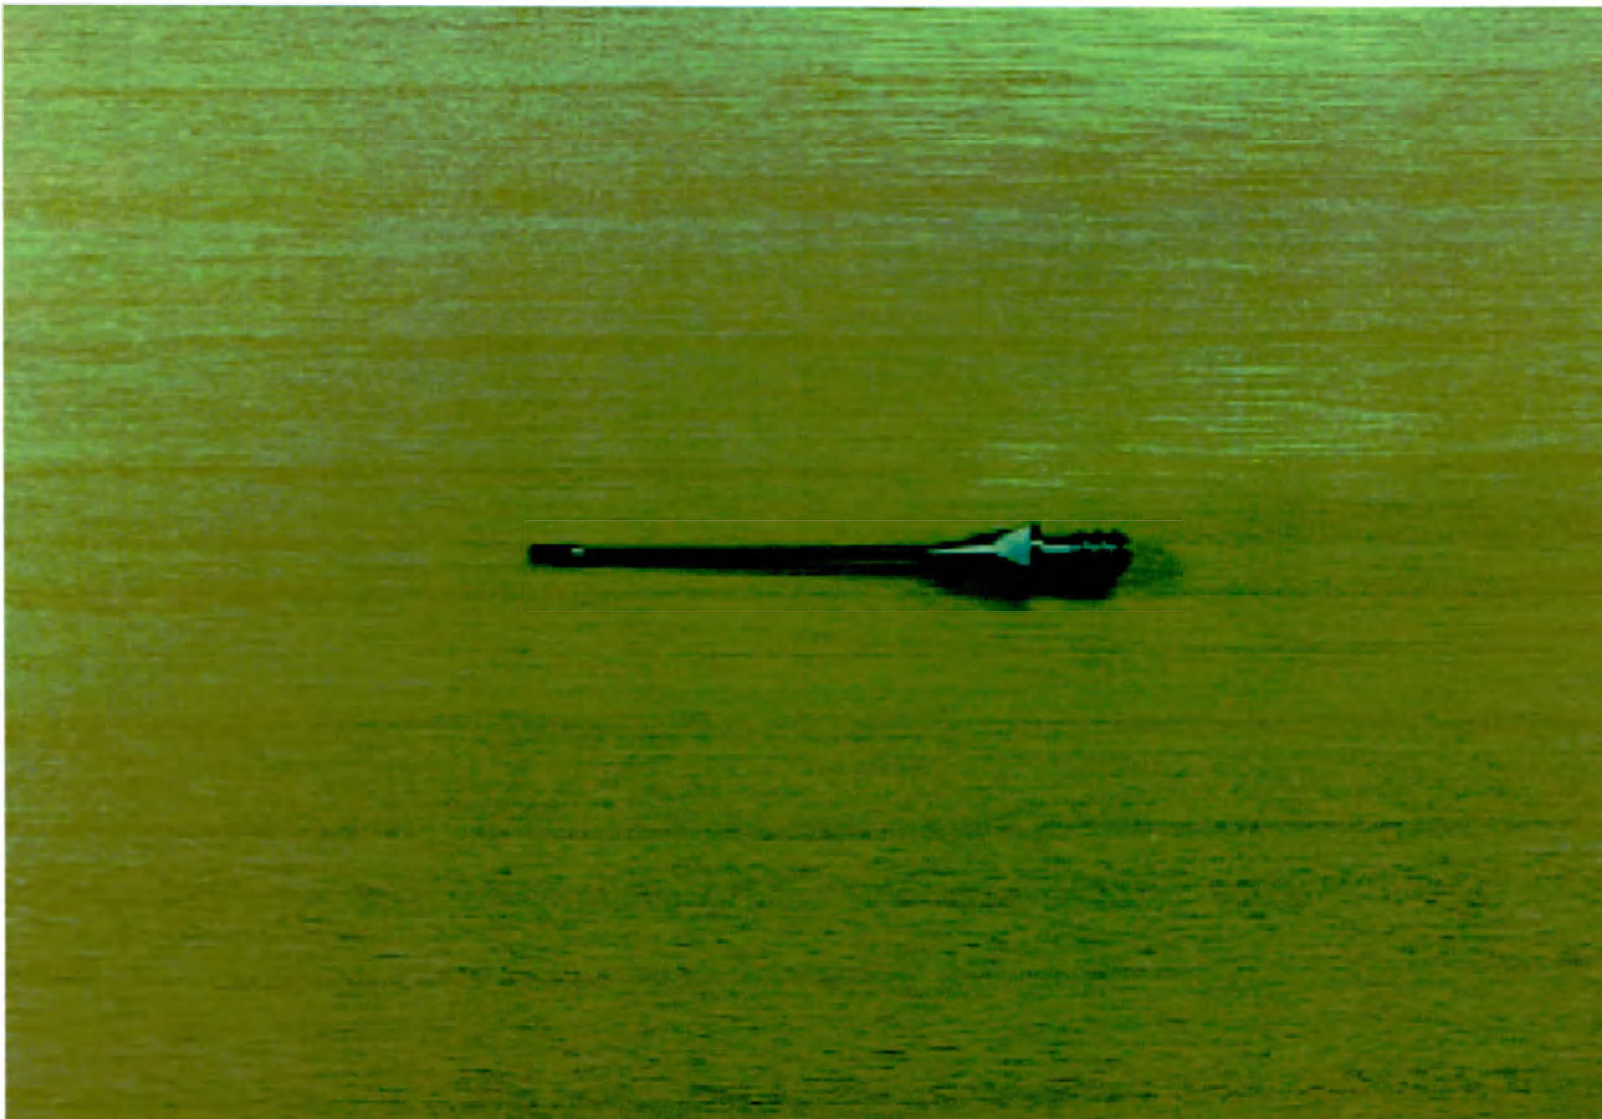

32. Макет маркировки на русском языке для обращения медицинского изделия в РФ.
«Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25 ga».

Набор для проведения факэмульсификации и/или витрэктомии для системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), в вариантах исполнения

Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 25 ga:

1. кассета и ирригационно-аспирационная система с принудительной инфузией AFI в сборе с соединителем Люэра, с зажимом, фильтром и двухходовым краником – 1 шт.;
2. Линия аспирационная, левая, с разъемами Люэра, 210 см – 1 шт.;
3. канюля инфузионная 25 ga с коннектором Люэра, 30 см, синяя – 1 шт.;
4. чехол для экрана Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
5. чехол для пульта дистанционного управления Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
6. чехол для лотка Майо Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
7. заглушка для закрытия отверстия на кассете – 1 шт.;
8. лоток для тестирования пневматического ножа bi-Blade® – 1 шт.;
9. соединитель Люэра – 1 шт.;
10. прокалыватель бутылки – 1 шт.;
11. пневматический нож bi-Blade® 25 ga – 1 шт.;
12. держатель со склеральными заглушками 25 ga (3 шт.), синие – 1 шт.;
13. эндоосветитель 25 ga с портом для подсоединения к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), синий, 219 см – 1 шт.;
14. троакар (нож типа ланцет с рукояткой и порт с клапаном) с колпачком в сборе 25 ga, синий – 3 шт.;
15. краник трехходовой, с соединителем Люэра – 1 шт.;
16. инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____. ____

Условия транспортировки/хранения: от -18 °C до + 60 °C.

Производитель: "Бауш энд Ломб Инкорпорейтед", США.

Bausch & Lomb Incorporated, 1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609, USA

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО "Бауш Хелс", РФ, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н., тел. +7 (495) 510-28-79, Russia.Claims@bausch.com

34. Макет маркировки на русском языке для обращения медицинского изделия в РФ. «Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 27 ga».

Набор для проведения факэмульсификации и/или витрэктомии для системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), в вариантах исполнения

Набор для задней пневматической витрэктомии с принудительной инфузией AFI 27 ga:

1. кассета и ирригационно-аспирационная система с принудительной инфузией AFI в сборе с зажимом, фильтром, двухходовым краником и капельницей – 1 шт.;
2. линия аспирационная, левая, с разъемами Люэра, 210 см – 1 шт.;
3. канюля инфузионная 27 ga с коннектором Люэра, 30 см, фиолетовая – 1 шт.;
4. чехол для экрана Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
5. чехол для пульта дистанционного управления Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
6. чехол для лотка Майо Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
7. заглушка для закрытия отверстия на кассете – 1 шт.;
8. лоток для тестирования пневматического ножа bi-Blade® – 1 шт.;
9. соединитель Люэра – 1 шт.;
10. прокалыватель бутылки – 1 шт.;
11. пневматический нож bi-Blade® 27 ga – 1 шт.;
12. эндоосветитель 27 ga с портом для подсоединения к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), фиолетовый, 219 см – 1 шт.;
13. троакары (нож типа ланцет с рукояткой и порт с клапаном) с колпачком в сборе 27 ga, фиолетовый – 3 шт.;
14. краник трехходовой, с соединителем Люэра – 1 шт.;
15. инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____. ____.

Условия транспортировки/хранения: от -18 °С до + 60 °С.

Производитель: "Бауш энд Ломб Инкорпорейтед", США.

Bausch & Lomb Incorporated, 1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609, USA

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО "Бауш Хелс", РФ, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н., тел. +7 (495) 510-28-79, Russia.Claims@bausch.com

35. Макет маркировки на русском языке для обращения медицинского изделия в РФ. «Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23 ga».

Набор для проведения факэмульсификации и/или витрэктомии для системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), в вариантах исполнения

Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 23 ga:

1. кассета и ирригационно-аспирационная система с принудительной инфузией AFI в сборе с зажимом, фильтром, двухходовым краником и капельницей – 1 шт.;
2. ключ для фиксации игл факэмульсификации, с металлическим наконечником – 1 шт.;
3. линия аспирационная, левая, с разъемами Люэра, 214 см – 1 шт.;
4. канюля инфузионная 23 ga с коннектором Люэра, 30 см, зеленая – 1 шт.;
5. чехол для экрана Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
6. чехол для пульта дистанционного управления Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
7. чехол для лотка Майо Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
8. заглушка для закрытия отверстия на кассете – 1 шт.;
9. тест-камера для тестирования ультразвуковой рукоятки к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite) – 1 шт.;
10. лоток для тестирования пневматического ножа – 1 шт.;
11. соединитель Люэра – 1 шт.;
12. слив ирригационный для иглы факэмульсификации, с внутренней резьбой для ультразвуковой рукоятки к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite) (для разреза 1,8 мм) – не более 2 шт.;
13. прокалывать бутылки – 1 шт.;
14. пневматический нож 23 ga – 1 шт.;
15. держатель со склеральными заглушками 23 ga (3 шт.), зеленые – 1 шт.;
16. эндоосветитель 23 ga с портом для подсоединения к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), зеленый, 219 см – 1 шт.;
17. троакар (нож типа ланцет с рукояткой и порт с клапаном) с колпачком в сборе 23 ga, зеленый – 3 шт.;
18. краник трехходовой, с соединителем Люэра – 1 шт.;
16. инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____. ____.

Условия транспортировки/хранения: от -18 °C до + 60 °C.

Производитель: "Бауш энд Ломб Инкорпорейтед", США.

Bausch & Lomb Incorporated, 1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609, USA

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО "Бауш Хелс", РФ, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н., тел. +7 (495) 510-28-79, Russia.Claims@bausch.com

36. Макет маркировки на русском языке для обращения медицинского изделия в РФ. «Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25 ga».

Набор для проведения факоэмульсификации и/или витрэктомии для системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), в вариантах исполнения

Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 25 ga:

1. кассета и ирригационно-аспирационная система с принудительной инфузией AFI в сборе с зажимом, фильтром, двухходовым краником и капельницей – 1 шт.;
2. ключ для фиксации игл факоэмульсификации, с металлическим наконечником – 1 шт.;
3. линия аспирационная, левая, с разъемами Люэра, 214 см – 1 шт.;
4. канюля инфузионная 25 ga с коннектором Люэра, 30 см, синяя – 1 шт.;
5. чехол для экрана Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
6. чехол для пульта дистанционного управления Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
7. чехол для лотка Майо Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
8. заглушка для закрытия отверстия на кассете – 1 шт.;
9. тест-камера для тестирования ультразвуковой рукоятки к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite) – 1 шт.;
10. лоток для тестирования пневматического ножа bi-Blade® – 1 шт.;
11. соединитель Люэра – 1 шт.;
12. слив ирригационный для иглы факоэмульсификации, с внутренней резьбой для ультразвуковой рукоятки к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite) (для разреза 1,8 мм) – не более 2 шт.;
13. прокалывать бутылки – 1 шт.;
14. пневматический нож bi-Blade® 25 ga – 1 шт.;
15. держатель со склеральными заглушками 25 ga (3 шт.), синие – 1 шт.;
16. эндоосветитель 25 ga с портом для подсоединения к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), синий, 219 см – 1 шт.;
17. троакар (нож типа ланцет с рукояткой и порт с клапаном) с колпачком в сборе 25 ga, синий – 3 шт.;
18. краник трехходовой, с соединителем Люэра – 1 шт.;
19. инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от ____ . ____ . ____

Условия транспортировки/хранения: от -18 °C до + 60 °C.

Производитель: "Бауш энд Ломб Инкорпорейтед", США.

Bausch & Lomb Incorporated, 1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609, USA

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО "Бауш Хелс", РФ, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н., тел. +7 (495) 510-28-79, Russia.Claims@bausch.com

37. Макет маркировки на русском языке для обращения медицинского изделия в РФ. «Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 27 ga».

Набор для проведения факоемульсификации и/или витрэктомии для системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), в вариантах исполнения

Набор для комбинированных процедур с принудительной инфузией AFI 27 ga:

1. кассета и ирригационно-аспирационная система с принудительной инфузией AFI в сборе с зажимом, фильтром, двухходовым краником и капельницей – 1 шт.;
2. ключ для фиксации игл факоемульсификации, с металлическим наконечником – 1 шт.;
3. линия аспирационная, левая, с разъемами Люэра, 214 см – 1 шт.;
4. канюля инфузионная 27 ga с коннектором Люэра, 30 см, фиолетовая – 1 шт.;
5. чехол для экрана Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
6. чехол для пульта дистанционного управления Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
7. чехол для лотка Майо Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
8. заглушка для закрытия отверстия на кассете – 1 шт.;
9. тест-камера для тестирования ультразвуковой рукоятки к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite) – 1 шт.;
10. лоток для тестирования пневматического ножа bi-Blade® – 1 шт.;
11. соединитель Люэра – 1 шт.;
12. слив ирригационный для иглы факоемульсификации, с внутренней резьбой для ультразвуковой рукоятки к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite) (для разреза 1,8 мм) – не более 2 шт.;
13. прокалыватель бутыли – 1 шт.;
14. пневматический нож bi-Blade® 27 ga – 1 шт.;
15. эндоосветитель 27 ga с портом для подсоединения к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), фиолетовый, 219 см – 1 шт.;
16. троакар (нож типа ланцет с рукояткой и порт с клапаном) с колпачком в сборе 27 ga, фиолетовый – 3 шт.;
17. краник трехходовой, с соединителем Люэра – 1 шт.;
18. инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____. ____.

Условия транспортировки/хранения: от -18 °C до + 60 °C.

Производитель: "Бауш энд Ломб Инкорпорейтед", США.

Bausch & Lomb Incorporated, 1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609, USA

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО "Бауш Хелс", РФ, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н., тел. +7 (495) 510-28-79, Russia.Claims@bausch.com

38. Макет маркировки на русском языке для обращения медицинского изделия в РФ. «Набор для бесшовной витрэктомии 25 ga».

Набор для проведения факэмульсификации и/или витрэктомии для системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), в вариантах исполнения

Набор для бесшовной витрэктомии 25 ga:

1. держатель со склеральными заглушками 25 ga (3 шт.), синие – 1 шт.;
2. канюля инфузионная 25 ga с коннектором Люэра, 30 см, синяя – 1 шт.;
3. троакар (нож типа ланцет с рукояткой и порт с клапаном) с колпачком в сборе 25 ga, синий – 3 шт.;
4. инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____. ____

Условия транспортировки/хранения: от -18 °C до + 60 °C.

Производитель: "Бауш энд Ломб Инкорпорейтед", США.

Bausch & Lomb Incorporated, 1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609, USA

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО "Бауш Хелс", РФ, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н., тел. +7 (495) 510-28-79, Russia.Claims@bausch.com

39. Макет маркировки на русском языке для обращения медицинского изделия в РФ. «Набор Adaptive Fluidics Premium для микроинвазивной факоемульсификации».

Набор для проведения факоемульсификации и/или витрэктомии для системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), в вариантах исполнения

Набор Adaptive Fluidics Premium для микроинвазивной факоемульсификации:

1. кассета и ирригационно-аспирационная система в сборе с фильтром, соединителем Люэра и зажимом – 1 шт.;
2. чехол для экрана Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
3. чехол для пульта дистанционного управления Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
4. чехол для лотка Майо Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
5. заглушка для закрытия отверстия на кассете – 1 шт.;
6. тест-камера для тестирования ультразвуковой рукоятки к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite) – 1 шт.;
7. ключ для фиксации игл факоемульсификации, с металлическим наконечником – 1 шт.;
8. прокалыватель бутылки – 1 шт.;
9. слив ирригационный для иглы факоемульсификации, с внутренней резьбой для ультразвуковой рукоятки к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite) (для разреза 2,4 мм) – 2 шт.;
10. наконечник (игла) для факоемульсификации трехступенчатая, прямая, расширяющаяся 2,0 мм MICS – 1 шт.;
11. инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____._____

Условия транспортировки/хранения: от -18 °С до + 60 °С.

Производитель: "Бауш энд Ломб Инкорпорейтед", США.

Bausch & Lomb Incorporated, 1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609, USA

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО "Бауш Хелс", РФ, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н., тел. +7 (495) 510-28-79, Russia.Claims@bausch.com

40. Макет маркировки на русском языке для обращения медицинского изделия в РФ. «Набор Adaptive Fluidics Standard для микроинвазивной фактоэмульсификации».

Набор для проведения фактоэмulsификации и/или витрэктомии для системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), в вариантах исполнения

Набор Adaptive Fluidics Standard для микроинвазивной фактоэмульсификации:

1. кассета и ирригационно-аспирационная система в сборе с фильтром, соединителем Люэра и зажимом – 1 шт.;
2. слив ирригационный для иглы факэмульсификации, с внутренней резьбой для ультразвуковой рукоятки к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), (для разреза 2,4 мм) - 2 шт.;
3. наконечник (игла) для факэмульсификации трехступенчатая, прямая, расширяющаяся 2,0 мм MICS – 1 шт.;
4. заглушка для закрытия отверстия на кассете 1 шт.;
5. тест-камера для тестирования ультразвуковой рукоятки к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite) – 1 шт.;
6. прокалыватель бутылки – 1 шт.;
7. чехол для экрана Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
8. чехол для пульта дистанционного управления Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
9. чехол для лотка Майо Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
10. ключ для фиксации игл факэмульсификации, с металлическим наконечником – 1 шт.;
11. инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от ____ . ____ . ____

Условия транспортировки/хранения: от -18 °С до + 60 °С.

Производитель: "Бауш энд Ломб Инкорпорейтед", США.

Bausch & Lomb Incorporated, 1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609, USA

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО "Бауш Хелс", РФ,
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н., тел. +7 (495) 510-28-79,
Russia.Claims@bausch.com

41. Макет маркировки на русском языке для обращения медицинского изделия в РФ. «Набор Adaptive Fluidics Basic для микроинвазивной факоемульсификации».

Набор для проведения факоемульсификации и/или витрэктомии для системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), в вариантах исполнения

Набор Adaptive Fluidics Basic для микроинвазивной факоемульсификации:

1. кассета и ирригационно-аспирационная система в сборе с фильтром, соединителем Люэра и зажимом – 1 шт.;
2. слив ирригационный для иглы факоемульсификации, с внутренней резьбой для ультразвуковой рукоятки к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), (для разреза 1,8 мм) - 2 шт.;
3. заглушка для закрытия отверстия на кассете – 1 шт.;
4. тест-камера для тестирования ультразвуковой рукоятки к Системе офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite) – 1 шт.;
5. прокалыватель бутыли – 1 шт.;
6. чехол для экрана Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
7. чехол для пульта дистанционного управления Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
8. чехол для лотка Майо Системы офтальмологической микрохирургической Стелларис Элит (Stellaris Elite), прозрачный – 1 шт.;
9. ключ для фиксации игл факоемульсификации, с металлическим наконечником – 1 шт.;
10. инструкция по применению – 1 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от ____ . ____ . ____

Условия транспортировки/хранения: от -18 °C до + 60 °C.

Производитель: "Бауш энд Ломб Инкорпорейтед", США.

Bausch & Lomb Incorporated, 1400 North Goodman Street, Rochester, NY 14609, USA

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО "Бауш Хелс", РФ, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1, помещ. 1Н., тел. +7 (495) 510-28-79, Russia.Claims@bausch.com



Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 44 листа (ов)

Старший специалист по регистрации
медицинских изделий

Потачина Ю.Э.

Подпись _____

« 20 » _____

