


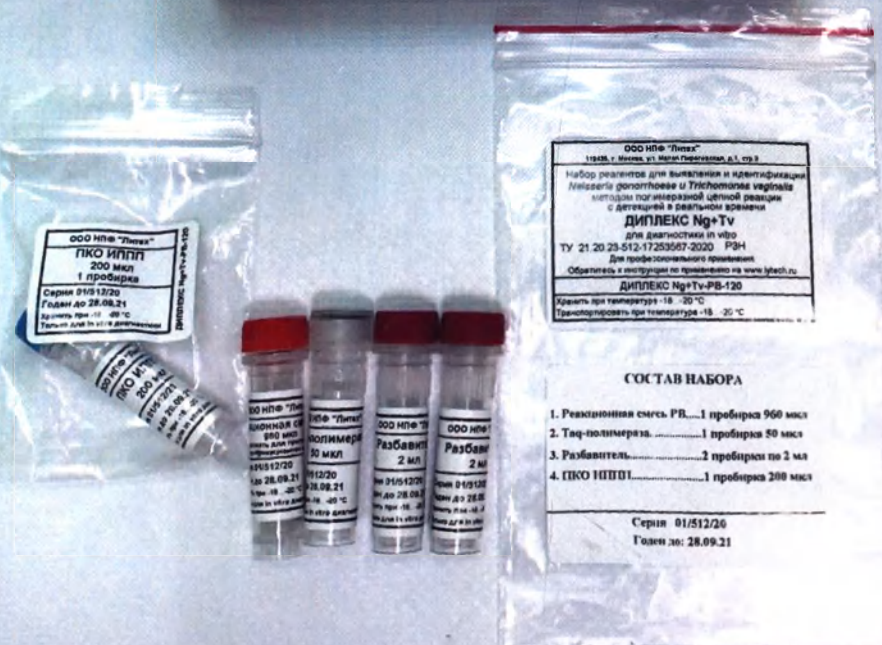

Вкладыш к набору ДИПЛЕКС Ng+Tv-PB-120

Номер серии набора 01/512/20

Дата изготовления 28.09.20 Годен до 28.09.21

Номер серии ПКО ИППП 120820

Дата изготовления 14.08.2020 Годен до 14.08.2022

ПКО ИППП представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов (образцов ДНК-мишеней *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis* и человека).

Наименование калибратора	Концентрация (ГЭ/мл)	Допустимый диапазон Ct
--------------------------	----------------------	------------------------

ПАМЯТКА

по применению набора реагентов для выявления и идентификации *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Ng+Tv для диагностики *in vitro*

Набор реагентов ДИПЛЕКС Ng+Tv предназначен для одновременного выявления, идентификации и количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот (НК), выделенных из клинических образцов (отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта, секрет предстательной железы, осадок мочи, отделяемое конъюнктивы, отделяемое слизистой ротоглотки).

1. Подготовка к проведению амплификации.

Маркировка пробирок на крышке возможна только для реал-тайм амплификатора Rotor-Gene Q, для всех остальных амплификаторов маркировка пробирок на крышке недопустима! В таком случае пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Вариант исполнения PB-120 («Нераскапанный»).

1.1.1. Приготовить и промаркировать необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контрольных образцов.

1.1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.



Вкладыш к набору ДИПЛЕКС Ng+Tv-OneStep-PB-60

Номер серии набора 01/08-544/20
Дата изготовления 19.11.20 Годен до 19.03.21
Номер серии ПКО ИППП 1408-20
Дата изготовления 14.08.2020 Годен до 14.08.2022

ПКО ИППП представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов (образцов ДНК-мишеней генов *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis* и человека).

Наименование калибратора	Концентрация (ГЭ/мл)	Допустимый диапазон Ct
--------------------------	----------------------	------------------------

ПАМЯТКА



по применению набора реагентов для выявления и идентификации *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Ng+Tv для диагностики *in vitro*

Набор реагентов ДИПЛЕКС Ng+Tv предназначен для одновременного выявления, идентификации и количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот (НК), выделенных из клинических образцов (отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта, секрет предстательной железы, осадок мочи, отделяемое конъюнктивы, отделяемое слизистой ротоглотки).

1. Подготовка к проведению амплификации.

Маркировка пробирок на крышке возможна только для реал-тайм амплификатора Rotor-Gene Q. Для всех остальных амплификаторов маркировка пробирок на крышке недопустима! В таком случае пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Вариант исполнения PB-120 («Нераскапанный»).

1.1.1. Приготовить и промаркировать необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контрольных образцов.

1.1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.

Фото 2. Набор реагентов ДИПЛЕКС Ng+Tv, вариант исполнения ДИПЛЕКС Ng+Tv-OneStep-PB-60.



Вкладыш
к набору ДИПЛЕКС Ng+Tv-OneStep-PB-96
 Номер серии набора 04/RS-574/20
 Дата изготовления 10.11.20 Годен до 10.03.21
 Номер серии ПКО ИППП 440160
 Дата изготовления 16.07.2020 Годен до 16.07.2022
 ПКО ИППП представляет собой количественно
 охарактеризованную смесь калибраторов (образцов ДНК-мишеней
 геномов *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis* и человека).

Наименование калибратора	Концентрация (Г/мл)	Допустимый диапазон Ct
-----------------------------	------------------------	---------------------------



ПАМЯТКА
 по применению набора реагентов для выявления и идентификации
Neisseria gonorrhoeae и *Trichomonas vaginalis*
 методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени
 ДИПЛЕКС Ng+Tv для диагностики *in vitro*

Набор реагентов ДИПЛЕКС Ng+Tv предназначен для одновременного выявления, идентификации и количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот (НЖ), выделенных из клинических образцов (отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта, секрет предстательной железы, осадок мочи, отделяемое конъюнктивы, отделяемое слизистой ротоглотки).

1. Подготовка к проведению амплификации.

Маркировка пробирок на крышке возможна только для реал-тайм амплификатора Rotor-Gene Q, для всех остальных амплификаторов маркировка пробирок на крышке недопустима! В таком случае пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Вариант исполнения PB-120 («Нераскапанный»).

1.1.1. Приготовить и промаркировать необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контрольных образцов.

1.1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.

Фото 3. Набор реагентов ДИПЛЕКС Ng+Tv, вариант исполнения ДИПЛЕКС Ng+Tv-OneStep-PB-96



Вкладыш к набору ДИПЛЕКС Ng+Tv-TwoStep-PB-60

Номер серии набора 01/TS-512/20

Дата изготовления 30.10.20 Годен до 30.04.21

Номер серии ПКО ИППП 1201-20

Дата изготовления 18.08.2020 Годен до 18.08.2022

ПКО ИППП представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов (образцов ДНК-мишеней *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis* и человека).

Наименование калибратора	Концентрация (ГЭ/мл)	Допустимый диапазон Ct
--------------------------	----------------------	------------------------

ПАМЯТКА



по применению набора реагентов для выявления и идентификации *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Ng+Tv для диагностики *in vitro*

Набор реагентов ДИПЛЕКС Ng+Tv предназначен для одновременного выявления, идентификации и количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот (НК), выделенных из клинических образцов (отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта, секрет предстательной железы, осадок мочи, отделяемое конъюнктивы, отделяемое слизистой ротоглотки).

1. Подготовка к проведению амплификации.


Маркировка пробирок на крышке возможна только для реал-тайм амплификатора Rotor-Gene Q, для всех остальных амплификаторов маркировка пробирок на крышке недопустима! В таком случае пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Вариант исполнения PB-120 («Нераскапанный»).

1.1.1. Приготовить и промаркировать необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контрольных образцов.

1.1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.

Фото 4. Набор реагентов ДИПЛЕКС Ng+Tv, вариант исполнения ДИПЛЕКС Ng+Tv-TwoStep-PB-60.

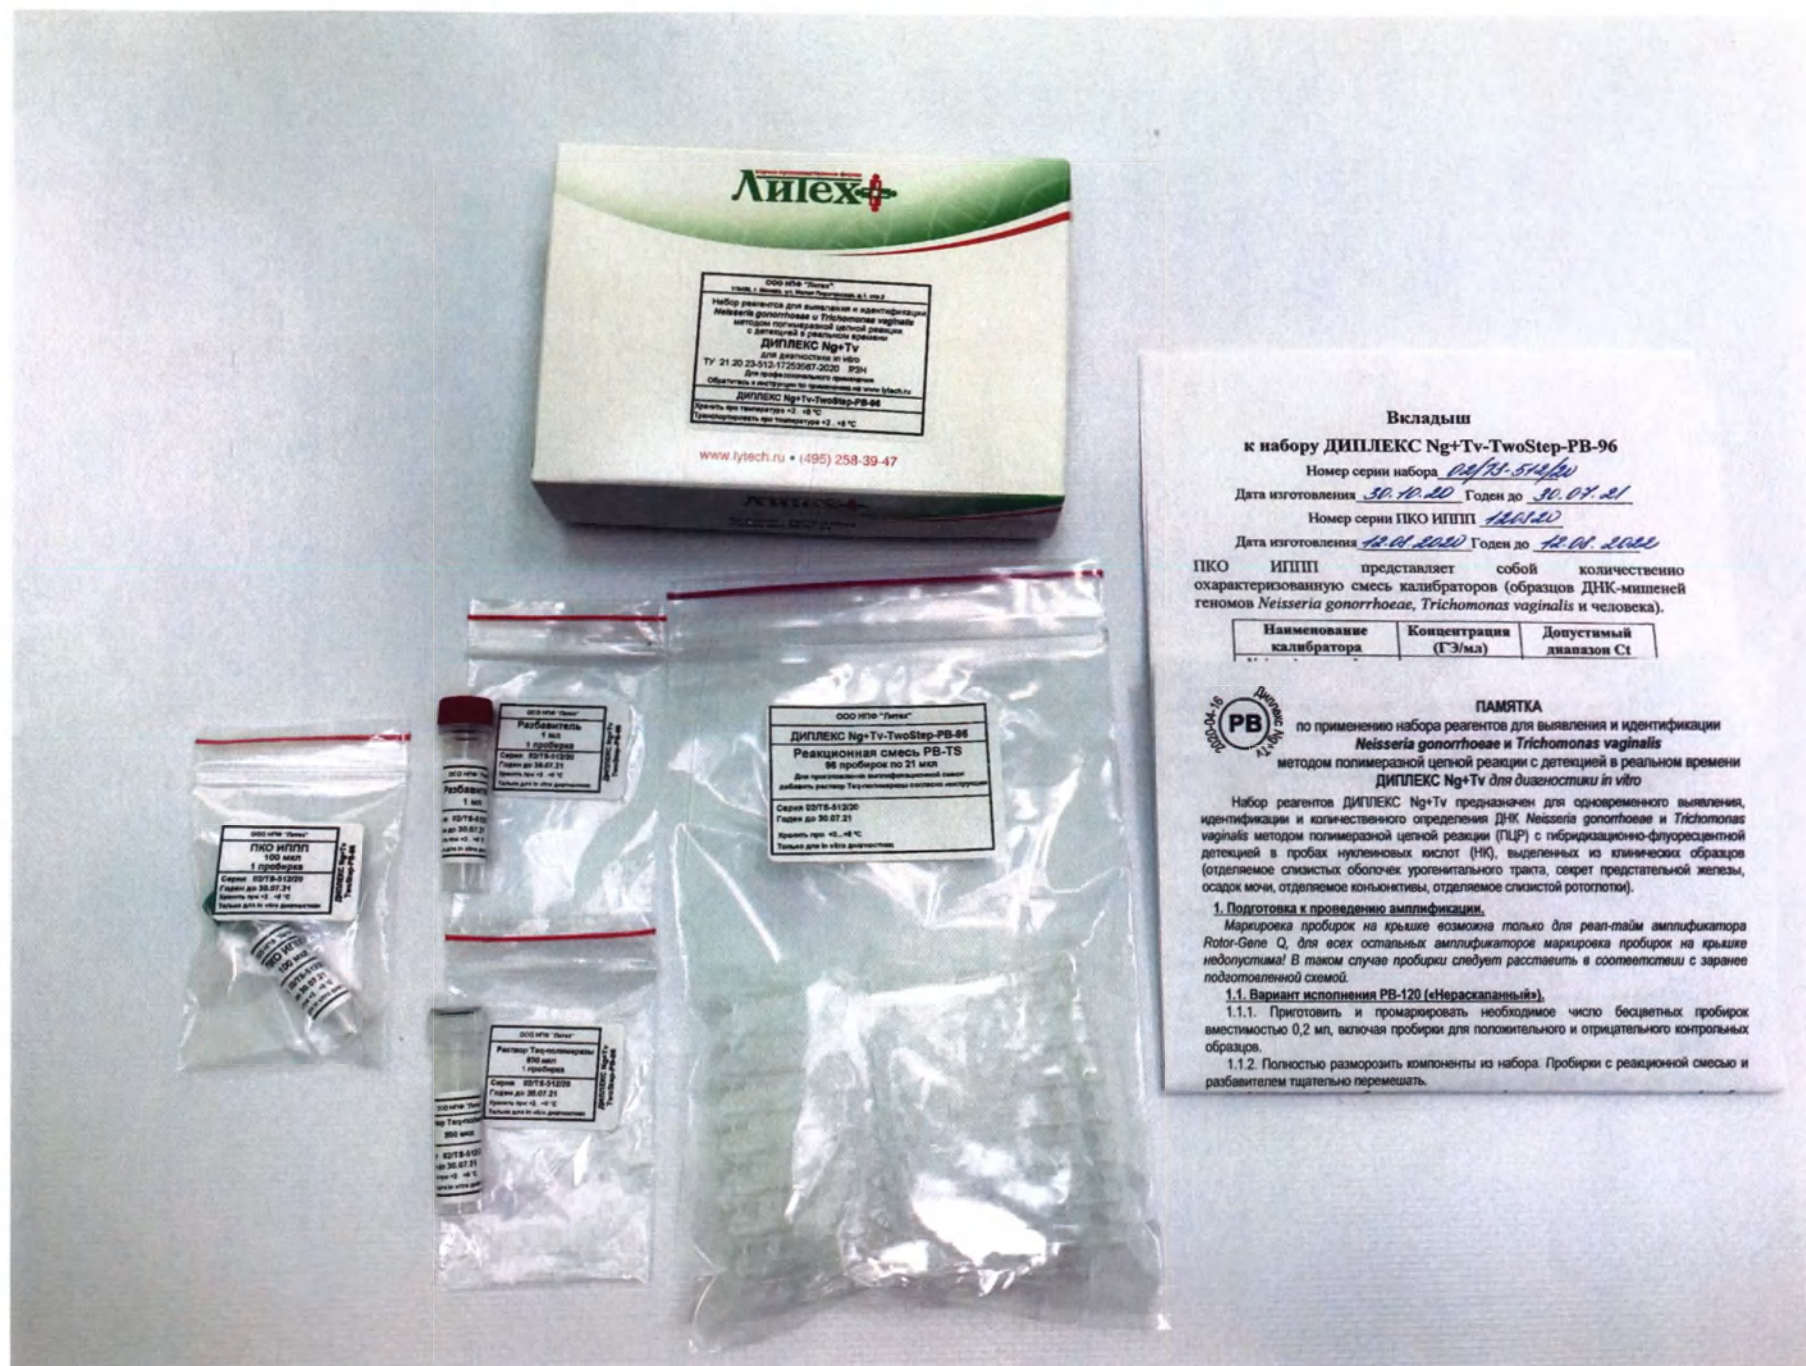

Вкладыш к набору ДИБЛЕКС Ng+Tv-TwoStep-PB-96

Номер серии набора 028/19-5146w

Дата изготовления 30.10.20 Годен до 30.07.21

Номер серии ПКО ИППП 1460240

Дата изготовления 14.01.2020 Годен до 14.01.2022

ПКО ИППП представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов (образцов ДНК-мишеней геномов *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis* и человека).

Наименование калибратора	Концентрация (ГЭ/мл)	Допустимый диапазон Ct
--------------------------	----------------------	------------------------



ПАМЯТКА

по применению набора реагентов для выявления и идентификации *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИБЛЕКС Ng+Tv для диагностики *in vitro*

Набор реагентов ДИБЛЕКС Ng+Tv предназначен для одновременного выявления, идентификации и количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот (НК), выделенных из клинических образцов (отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта, секрет предстательной железы, осадок мочи, отделяемое конъюнктивы, отделяемое слизистой ротоглотки).

1. Подготовка к проведению амплификации.

Маркировка пробирок на крышке возможна только для реал-тайм амплификатора Rotor-Gene Q, для всех остальных амплификаторов маркировка пробирок на крышке недопустима! В таком случае пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Вариант исполнения PB-120 («Нераскапанный»).

1.1.1. Приготовить и промаркировать необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контрольных образцов.

1.1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.

Фото 5. Набор реагентов ДИБЛЕКС Ng+Tv, вариант исполнения ДИБЛЕКС Ng+Tv-TwoStep-PB-96.



Фото 6. Набор реагентов ДИПЛЕКС Ng+Tv, вариант исполнения ДИПЛЕКС Ng+Tv Групповая упаковка.

Прошито, проверено,
скреплено печатью.

Количество листов

шт.

Директор

Наумов А.Ю.





ООО НПФ "Литех"
119499, г. Москва, ул. Мещеряковская, д. 1, стр. 3
Набор реагентов для выявления и идентификации
Neisseria gonorrhoeae и *Trichomonas vaginalis*
методом полимеразной цепной реакции
с детекцией в реальном времени
ДИПЛЕКС Ng+Tv
для диагностики in vitro
ТУ 21.20.23-512-17253567-2020 РЭН
Для профессионального применения
Обратиться к инструкции по применению на сайте lytech.ru
ДИПЛЕКС Ng+Tv-PB-120
Хранить при температуре -18...-20 °C
Транспортировать при температуре -18...-20 °C

СОСТАВ НАБОРА


1. Реакционная смесь PB...1 пробирка 960 мкл
2. Taq-полимераза...1 пробирка 50 мкл
3. Разбавитель...2 пробирки по 2 мл
4. ПКО (ИППП)...1 пробирка 200 мкл

Серия 01/512/20
Годен до: 28.09.21

Вкладыш
к набору ДИПЛЕКС Ng+Tv-PB-120
Номер серии набора 01/512/20
Дата изготовления 28.09.20 Годен до 28.09.21
Номер серии ПКО ИППП 120520
Дата изготовления 12.08.2020 Годен до 12.08.2022

ПКО ИППП представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов (образцов ДНК-мишеней генов *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis* и человека).

Наименование калибратора	Концентрация (ГЭ/мл)	Допустимый диапазон Ct
--------------------------	----------------------	------------------------



ПАМЯТКА

по применению набора реагентов для выявления и идентификации *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени **ДИПЛЕКС Ng+Tv для диагностики in vitro**

Набор реагентов ДИПЛЕКС Ng+Tv предназначен для одновременного выявления, идентификации и количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот (НК), выделенных из клинических образцов (отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта, секрет предстательной железы, осадок мочи, отделяемое конъюнктивы, отделяемое слизистой ротоглотки).

1. Подготовка к проведению амплификации.
Маркировка пробирок на крышке возможна только для реал-тайм амплификатора Rotor-Gene Q, для всех остальных амплификаторов маркировка пробирок на крышке недопустима! В таком случае пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Вариант исполнения PB-120 («Нераскапанный»).
1.1.1. Приготовить и промаркировать необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контрольных образцов.
1.1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.

Фото 1. Набор реагентов ДИПЛЕКС Ng+Tv, вариант исполнения ДИПЛЕКС Ng+Tv-PB-120.



Фото 2. Набор реагентов ДИПЛЕКС Ng+Tv, вариант исполнения ДИПЛЕКС Ng+Tv-OneStep-PB-60.

Вкладыш

к набору ДИПЛЕКС Ng+Tv-OneStep-PB-60

Номер серии набора 01/05-514/20

Дата изготовления 19.11.20 Годен до 19.03.21

Номер серии ПКО ИППП 1405/20

Дата изготовления 12.08.2020 Годен до 12.08.2022

ПКО ИППП представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов (образцов ДНК-мишеней геномов *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis* и человека).

Наименование калибратора	Концентрация (ГЭ/мл)	Допустимый диапазон Ct
--------------------------	----------------------	------------------------

ПАМЯТКА



по применению набора реагентов для выявления и идентификации *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Ng+Tv для диагностики *in vitro*

Набор реагентов ДИПЛЕКС Ng+Tv предназначен для одновременного выявления, идентификации и количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот (НК), выделенных из клинических образцов (отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта, секрет предстательной железы, осадок мочи, отделяемое конъюнктивы, отделяемое слизистой ротоглотки).

1. Подготовка к проведению амплификации.

Маркировка пробирок на крышке возможна только для реал-тайм амплификатора Rotor-Gene Q, для всех остальных амплификаторов маркировка пробирок на крышке недопустима! В таком случае пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Вариант исполнения PB-120 («Нераскаланный»).

1.1.1. Приготовить и промаркировать необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контрольных образцов.

1.1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.



Вкладыш
к набору ДИПЛЕКС Ng+Tv-OneStep-PB-96

Номер серии набора 08/08-512/20
Дата изготовления 18.11.20 Годен до 18.01.21
Номер серии ПКО ИППП 100120
Дата изготовления 11.08.2020 Годен до 11.01.2022

ПКО ИППП представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов (образцов ДНК-мишеней геномов *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis* и человека).

Наименование калибратора	Концентрация (ГЭ/мл)	Допустимый диапазон Ct
--------------------------	----------------------	------------------------



ПАМЯТКА
по применению набора реагентов для выявления и идентификации *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Ng+Tv для диагностики *in vitro*

Набор реагентов ДИПЛЕКС Ng+Tv предназначен для одновременного выявления, идентификации и количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридолизационно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот (НК), выделенных из клинических образцов (отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта, секрет предстательной железы, осадок мочи, отделяемое конъюнктивы, отделяемое слизистой ротоглотки).

1. Подготовка к проведению амплификации.

Маркировка пробирок на крышке возможна только для реал-тайм амплификатора Rotor-Gene Q, для всех остальных амплификаторов маркировка пробирок на крышке недопустима! В таком случае пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Вариант исполнения PB-120 («Нераскапанный»).

1.1.1. Приготовить и промаркировать необходимое число беззатехных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контрольных образцов.

1.1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.

Фото 3. Набор реагентов ДИПЛЕКС Ng+Tv, вариант исполнения ДИПЛЕКС Ng+Tv-OneStep-PB-96



Вкладыш **к набору ДИПЛЕКС Ng+Tv-TwoStep-PB-60**

Номер серии набора 01/75-574/20

Дата изготовления 30.10.20 Годен до 30.04.21

Номер серии ПКО ИППП 1201-20

Дата изготовления 12.08.2020 Годен до 12.08.2022

ПКО ИППП представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов (образцов ДНК-мишеней геномов *Neisseria gonorrhoeae*, *Trichomonas vaginalis* и человека).

Наименование калибратора	Концентрация (ГЭ/мл)	Допустимый диапазон Ct
--------------------------	----------------------	------------------------

ПАМЯТКА

по применению набора реагентов для выявления и идентификации *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС Ng+Tv для диагностики in vitro

Набор реагентов ДИПЛЕКС Ng+Tv предназначен для одновременного выявления, идентификации и количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoeae* и *Trichomonas vaginalis* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией в пробах нуклеиновых кислот (НК), выделенных из клинических образцов (отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта, секрет предстательной железы, осадок мочи, отделяемое конъюнктивы, отделяемое слизистой ротоглотки).

1. Подготовка к проведению амплификации.

Маркировка пробирок на крышке возможна только для реал-тайм амплификатора Rotor-Gene Q. Для всех остальных амплификаторов маркировка пробирок на крышке недопустима! В таком случае пробирки следует расставить в соответствии с заранее подготовленной схемой.

1.1. Вариант исполнения PB-120 («Нераскапанный»).

1.1.1. Приготовить и промаркировать необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 0,2 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного контрольных образцов.

1.1.2. Полностью разморозить компоненты из набора. Пробирки с реакционной смесью и разбавителем тщательно перемешать.

Фото 4. Набор реагентов ДИПЛЕКС Ng+Tv, вариант исполнения ДИПЛЕКС Ng+Tv-TwoStep-PB-60.

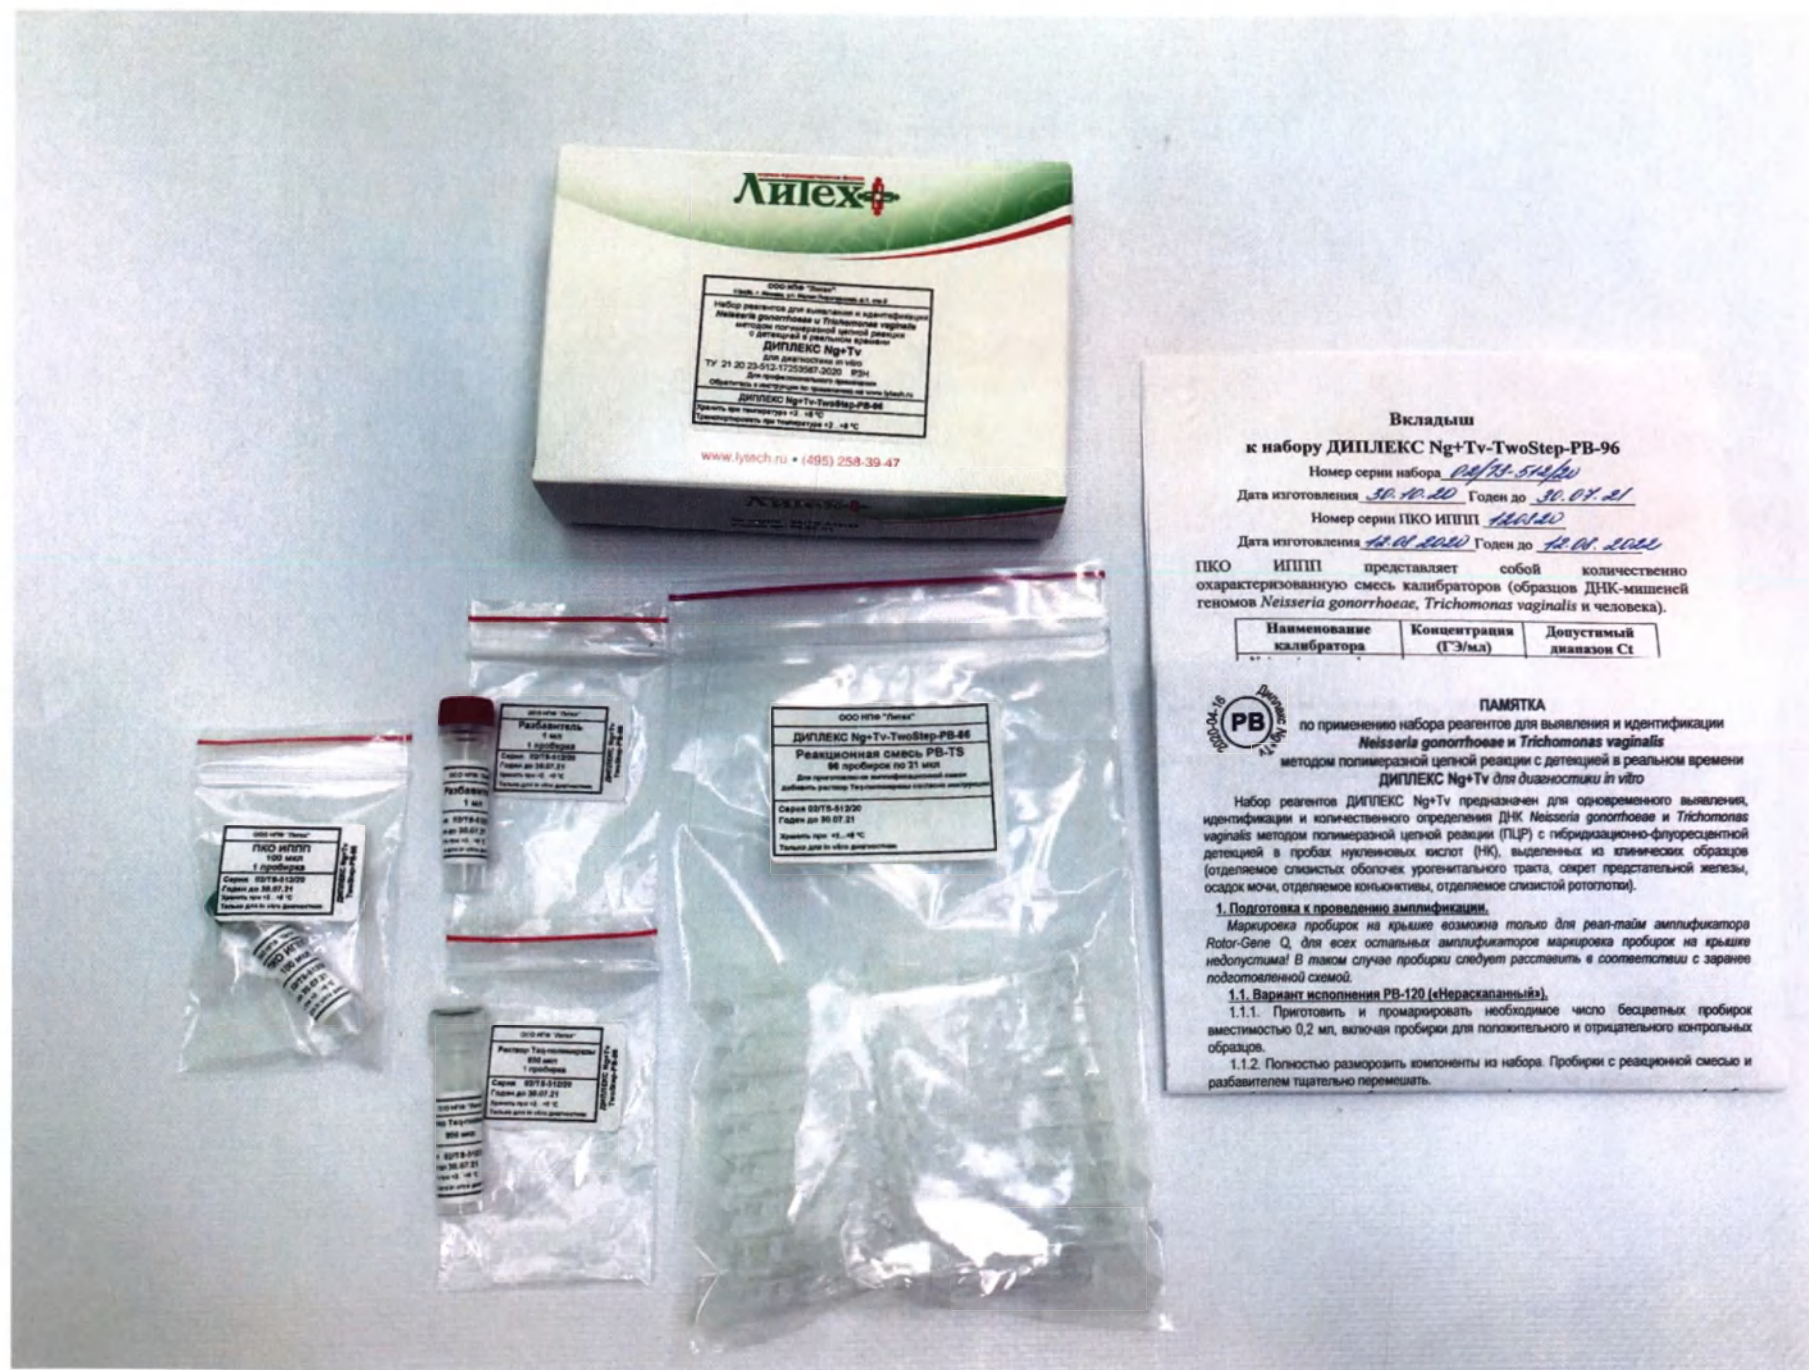


Фото 5. Набор реагентов ДИПЛЕКС Ng+Tv, вариант исполнения ДИПЛЕКС Ng+Tv-TwoStep-PB-96.



Фото 6. Набор реагентов ДИПЛЕКС Ng+Tv, вариант исполнения ДИПЛЕКС Ng+Tv Групповая упаковка.

Прошито, проверено,
скреплено печатью.

Количество листов

5 шт.

Директор

Наумов А.Ю.

