

научно-производственная фирма
Литех

ООО НПО "Литех"
119435 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 1, стр. 2
Набор реагентов для выявления и идентификации
HSV type 1 и HSV type 2
методом полимеразной цепной реакции
с детекцией в реальном времени
ДИПЛЕКС HSV I-II
для диагностики in vitro
ТУ 21-20-23-530-17253567-2016 РСР
ДИПЛЕКС HSV I-II-PS-128
Хранить при температуре 18 - 20 °С
транспортировать при температуре +2 - 8 °С не более 1 суток
Только для in vitro диагностики

www.lytech.ru • (495) 258-39-47

научно-производственная фирма
Литех

Регистрация: 04.03.2016
годен до: 18.08.19

СЧЕТЫ НАЛОГА

1. Расчетная сумма НДС	1 рубль 00 коп.
2. Сумма налога	1 рубль 00 коп.
3. Расчетная сумма НДС	1 рубль 00 коп.
4. Сумма налога	1 рубль 00 коп.

Сумма: 11 руб. 00 коп.

Сумма: 11 руб. 00 коп.

[illegible]

Компонент	Количество (мг)
Разбавитель	
Реакционная смесь	
Тaq-полимераза	

1.4. Перемешать амплификационную смесь вortexированием в течение 10 секунд.

1.5. Внести в приготовленные амплификационной смеси.

Перейти к пункту 4.

Номер серии набора 01/530/18 Дата изготовления 18.06.18 Годен до 18.06.19
Номер серии ПКО инпл. 03/18 Дата изготовления 15.03.18 Годен до 15.03.20
ПКО инпл. _____

ЛКО ИППП представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов, содержащих фрагменты ДНК *HSF type 1*, *HSF type 2*, и человека.

Наименование калибратора	Концентрация (Г/мл)	Допустимый диапазон Ст
HSV type 1	$2,30 \cdot 10^5$	22,6 - 26,6
HSV type 2	$4,50 \cdot 10^3$	24,0 - 28,0
ДНК человека	$9,5 \cdot 10^1$	22,1 - 26,1


Начальник отдела контроля производства металлических изделий

[illegible]

№	Комплексы	Набор в серию
1	1 прибор - 300 мкл	Витаминный
2	1 прибор - 50 мкл	Прогнозная величина развития плода
3	2 прибора - по 2 мл	Прогнозная биологическая величина жидких тканей
4	1 прибор - 200 мкл	Прогнозная биологическая величина
5	1 прибор - 200 мкл	Прогнозная биологическая величина

[illegible]

982
999
1032

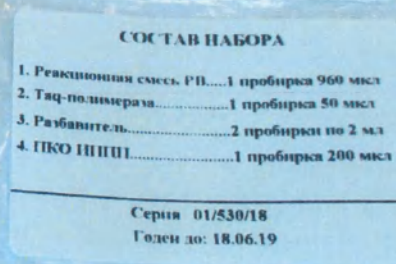

научно-производственная фирма
Литех

ООО НПФ "Литех"
119434, Москва, ул. Мясницкая, д. 1, стр. 3

Набор реагентов для выявления и идентификации
HSV type 1 и HSV type 2
методом полимеразной цепной реакции
с детекцией в реальном времени
ДИПЛЕКС HSV I+II
для диагностики in vitro
ТУ 21 20 23-530-17253567-2018ФСР

ДИПЛЕКС HSV I+II-OneStep-PB-60

Хранить при температуре -18 -20 °С
Транспортировать при температуре +2 - 8 °С не более 1 суток
Только для in vitro диагностики

www.lytech.ru • (495) 258-39-47

научно-производственная фирма
Литех

№ серии : 02/05-530/18
годен до : 18.10.18



ПАМЯТКА
по применению набора реагентов для выявления и идентификации
HSV type 1 и HSV type 2
методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени
ДИПЛЕКС HSV 1+2
для диагностики in vitro

1. Подготовка к проведению идентификации. маркирует
Неразбавленный РВ.
1.1. Приготовить необходимое число бесцветных пробирок вместимостью 1 мл, включая пробирки для положительного и отрицательного образцов.
Маркировка пробирок на крышке помаскирована только для амплификатора Rotar Gene, для всех остальных амплификаторов пробирки не маркируются! В таком случае пробирки следует маркировать на крышке непосредственно перед использованием.
1.2. Полностью разложить компоненты из набора. Пробирки с смесью и разбавителями тщательно перемешать.
1.3. Из компонентов набора приготовить смесь из расчета на 10

Комп-
Разб-
Рез-
Тарг-

Рекомендуется для приготовления смеси наклонением.
1.4. Перемешать, центрифугировать в т.
1.5. Внести в амплификационную с.
Перейти к пункту

Вкладыш к набору ДИПЛЕКС HSV 1+2

Номер серии набора 04/01-530/11 Дата изготовления 18.06.18 Годен до 18.10.18
Номер серии ПКО ИПП 03/18 Дата изготовления 18.06.18 Годен до 18.09.20

ПКО ИПП представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов, содержащих фрагменты ДНК HSV type 1, HSV type 2 и человека.

Наименование калибратора	Концентрация (ГЭ/мл)	Допустимый диапазон Ct
HSV type 1	$2,30 \cdot 10^5$	22,6 - 26,6
HSV type 2	$4,50 \cdot 10^5$	24,0 - 28,9
ДНК человека	$9,5 \cdot 10^5$	22,1 - 26,1

Липтех НАС ПЕРТ КАЧЕСТВА № 03/01-530/11
Набор реагентов для выявления и идентификации
HSV type 1 и HSV type 2
методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени
«ДИПЛЕКС HSV 1+2»
для диагностики in vitro № ТУ 21.20.23-530-17153-567-2018

ДИПЛЕКС HSV 1+2-OneStep-PB-60
производитель ООО ИПФ «Липтех», Москва 119435, ул. Малая Пятницкая 1 стр. 2, тел. 8499 278-
серия 04/01-530/11 Дата изготовления 18.06.18 Набор в серии 72

Характеристика	Состав	Концентрация	Вспомогат. акт.
Идентификационная смесь РВ-СВ	по пробиркам по 28 мкл	Пробирки бесцветная жидкость под крышкой	Пробирки бесцветная жидкость под крышкой
Вспомогат. акт.	1 пробирка - 1 мл	Пробирки бесцветная жидкость	Пробирки бесцветная жидкость
Вспомогат. акт.	1 пробирка - 100 мкл	Пробирки бесцветная жидкость	Пробирки бесцветная жидкость

Идентификация показателя	Характеристика и норма по ТУ	Результаты контроля
Согласно п. 1.4. ТУ	Содержит: - калибраторы: - смесь из амплификационной смеси РВ-СВ, смеси РВ-СВ и смеси РВ-СВ и смеси РВ-СВ	Содержит: - калибраторы: - смесь из амплификационной смеси РВ-СВ, смеси РВ-СВ и смеси РВ-СВ и смеси РВ-СВ
Согласно п. 1.6. ТУ	Содержит: Амплификационную смесь РВ-СВ, смесь РВ-СВ и смеси РВ-СВ и смеси РВ-СВ	Содержит: Амплификационную смесь РВ-СВ, смесь РВ-СВ и смеси РВ-СВ и смеси РВ-СВ
Согласно п. 1.5. ТУ	Содержит: На каждый компонент набора, индивидуально расфасованный, наклеена этикетка согласно п. 1.5.1. ТУ	Содержит: На каждый компонент набора, индивидуально расфасованный, наклеена этикетка согласно п. 1.5.1. ТУ
1900	1000	1017
1000	1000	989
1000	1000	962
Детекция фрагмента ДНК HSV type 1, HSV type 2	Детекция фрагмента ДНК HSV type 1, HSV type 2	Детекция фрагмента ДНК HSV type 1, HSV type 2



Литех

ООО ИПО "Литех"
Набор реагентов для выявления и идентификации
HSV type 1 и HSV type 2
методом полимеразной цепной реакции
с детекцией в реальном времени
ДИПЛЕКС HSV I+II
для диагностики in vitro
ТУ 21 20 23-530-17253567-2018ФСР
ДИПЛЕКС HSV I+II-OneStep-PB-96
Хранить при температуре -18 -20 °С
Транспортировать при температуре +2 -8 °С не более 1 суток
Только для in vitro диагностики

www.lytech.ru • (495) 258-39-47

Литех

№ серии : 01/OS-530/18
годен до : 18.10.19

СОСТАВ НАБОРА

1. Амплификационная смесь РВ-ОС 96 пробирок по 28 мкл
 2. ПКО ИППП 1 пробирка 100 мкл
 3. Разбавитель 1 пробирка 1 мл

Серия: 01.05.530/18
 Год изг. 18.10.18

ПАМЯТКА
 по применению набора реагентов для выявления
 HSV type 1 и HSV type 2
 методом полимеразной цепной реакции с детекцией
 ДИПЛЕКС HSV INI
 для диагностики HSV

1. Подготовка к проведению амплификации.
 1.1. Препаровать необходимое число бесцветных мп, выложенных пробирок для положительного образца.
 Маркировка пробирок на крышке: «Амплификационная смесь РВ-ОС», «ПКО ИППП», «Разбавитель», «Тaq-полимераза».
 1.2. Полностью разморозить компоненты смеси и разбавителем тщательно перемешать.
 1.3. Из компонентов набора приготовить смесь

Компонент	
Разбавитель	
Реакционная смесь	
Taq-полимераза	

приготовлении смеси
 1.4. Перемешать
 вортированием в
 1.5. Внести
 Перейти к пунт

**Вкладыш
 к набору ДИПЛЕКС HSV1+2**

Номер серии набора: 01/05-530/18 Дата изготовления: 18.10.18 Год изг. 2018
 Номер серии ПКО ИППП: 11 Дата изготовления: 18.03.18 Год изг. 2018

ПКО ИППП представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов, содержащих фрагменты ДНК HSV type 1, HSV type 2 и человека.

Наименование калибратора	Концентрация (ГЭ/мл)	Допустимый диапазон А ₂₆₀
HSV type 1	2.30*10 ⁴	22,1 - 26,6
HSV type 2	4.50*10 ⁴	24,0 - 28,9
Человек	9.5*10 ⁴	22,1 - 26,1


ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 01/05-530/18
 Набор реагентов для выявления и идентификации HSV type 1 и HSV type 2 методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени «ДИПЛЕКС HSV 1+2» для диагностики HSV type 1 и HSV type 2
 ДИПЛЕКС HSV 1+2 OneStep-РВ-96
 Изготовитель: ООО «Липекс», Москва 119415, ул. Малая Пироговская, д.3, вкл. 1899/258
 от 01/05-530/18 Дата изготовления: 18.03.18 Наборов в серии: 84

Состав	Количество	Потенциал
Амплификационная смесь РВ-ОС	96 пробирок по 28 мкл	Пропорция бесцветная жидкость (на фоне желтой прозрачной жидкости)
ПКО	1 пробирка - 1 мл	Пропорция бесцветная жидкость
ИППП	1 пробирка - 100 мкл	Пропорция бесцветная жидкость

Исходные показатели	Характеристики и норма по ТУ	Результаты контроля
Оптическая плотность	Согласно п. 1.4. ТУ	Соответствует В комплекте поставки входят: - набор реагентов; - пакеты по применению набора; - вкладыши с данными ПКО ИППП; - паспорт.
Внешний вид	Согласно п. 1.6. ТУ	Соответствует Амплификационная смесь РВ-ОС расфасована в стропы из поликарбонатных пробирок с крышками вместимостью 0,2 мл. Разбавитель и ПКО ИППП расфасованы в поликарбонатные пробирки с крышками вместимостью 1 мл и 100 мкл соответственно. Крышки и пробирки имеют маркировку и упакованы по отдельности в пакеты-термопары из поликарбоната. Комплектация набора, вкладыши, паспорт и паспорт упакованы в коробку-поддон.

1000	
1000	
1000	

фрагменты ДНК HSV type 1, ДНК HSV type 2, ДНК HSV type 2



научно-производственная фирма
Литех

ООО НПФ "Литех"
118436, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.1, стр.3

Набор реагентов для выявления и идентификации
HSV type 1 и HSV type 2
методом полимеразной цепной реакции
с детекцией в реальном времени
ДИПЛЕКС HSV I+II
для диагностики in vitro
ТУ 21 20 23-530-17253587-2018ФСР

ДИПЛЕКС HSV I+II-TwoStep-PS-60

Хранить при температуре +2...8°C
Транспортировать при температуре +2...8°C
Только для in vitro

www.lytech.ru • (495) 258-39-47

научно-производственная фирма
Литех

№ серии : 02/TS-630/18
Годен до 20.03.19

1. Работоспособность электр. привода	50 процентов по 21 месту
2. ИБСЗ ИИИИИ	1 процент по 100 месту
3. Работоспособность	1 процент по 1 месту
4. Работосп. Тар. индустриализации	1 процент по 100 месту

Средн. 02/ТУ 038/16

ПАМ'ЯТКА
по правильному вибору реактивів для аналізу на
HIV типу 1 та HIV типу 2
системою полімеразної ланцюгової реакції з детекцією
ДНПЛЕС HIV 1+2
для діагностики інфекції HIV

1. Подготовка к проведению аттестации в
назначенный РВ.

1.3. Привести необходимое число безданных проблем, включая пробирки для количественного и отрицательного.

Маршруты пробок на крыше возможны только для автомобиля Rover Gene. Для всех остальных авто пробок на крыше недопустимо! В таком случае пробка в соответствии с маркировкой подготавливается

1.2 Полностью разморозить компоненты из набора смесью и разбавителем тщательно перемешать.

1.3. Из компонентов набора приготовить смесь из р-

Компонент	Конц
Разбавитель	21
Реакционная смесь	7
Тaq-полимераза	0,3

Рекомендуется готовить смесь реактивов не в
приготовлении смеси необходимо все компоненты
компонента (ММ)

1.4. Перемешивание в вихревых аппаратах

1.5. Внести

1.3. Внести
амплификационной

Дерейтм ы тун

Вкладыш
к набору ДИПЛЕКС HSVI+II

Номер серии 02/03/18 Дата изготовления 04.06.18 Годен до 20.09.19
Номер серии ЛКО ИПП 03/18 Дата изготовления 15.03.18 Годен до 15.03.19

ДНК-матрица представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов, содержащих фрагменты ДНК HSV type 1, HSV type 2, и человека.

Наименование калибратора	Концентрация (Γ /мл)	Допустимый диапазон Сг
HSI type 1	$2,30 \cdot 10^3$	22,0 - 26,6
HSI type 2	$4,50 \cdot 10^3$	24,0 - 28,0
ДНК человека	$9,5 \cdot 10^4$	22,1 - 26,1

РАЙОННАЯ № 04/13-330/11
Ген. деп. администрации в экстр. исполнении
ИДН № 1 в 1028 тип 2
СЛУЖБ. ПРОВЕРКА в отношении в отношении
-ДОМАШ. ИДН 1-01-
в 1028 тип 2, 1028 тип 2, 1028 тип 2, 1028 тип 2

ΔEKC HSY 1+H-TwoStep-PB-60

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» 1985. 208 с. 1500 экз.

Дата изготовления 2006 г. Изготовлен в серии 34

[illegible]

Национальный отдел контроля качества медицинских изделий

Case 02-1-530-18
Folio 20, 21, 22
Folios 23, 24
Folios 25, 26
Folios 27, 28
Folios 29, 30
Folios 31, 32
Folios 33, 34
Folios 35, 36
Folios 37, 38
Folios 39, 40
Folios 41, 42
Folios 43, 44
Folios 45, 46
Folios 47, 48
Folios 49, 50
Folios 51, 52
Folios 53, 54
Folios 55, 56
Folios 57, 58
Folios 59, 60
Folios 61, 62
Folios 63, 64
Folios 65, 66
Folios 67, 68
Folios 69, 70
Folios 71, 72
Folios 73, 74
Folios 75, 76
Folios 77, 78
Folios 79, 80
Folios 81, 82
Folios 83, 84
Folios 85, 86
Folios 87, 88
Folios 89, 90
Folios 91, 92
Folios 93, 94
Folios 95, 96
Folios 97, 98
Folios 99, 100

BAGUETTE

BAGUETTE

научно-производственная фирма
Литех

ООО ИФФ "Литех"
194040, г. Москва, ул. Новомосковский вл. 1, стр. 1
Набор реагентов для выявления и идентификации
HSV type 1 и HSV type 2
методом полимеразной цепной реакции
с детекцией в реальном времени
ДИПЛЕКС HSV I+II
для диагностики in vitro
ТУ 21 20 23-530-17253567-2018ФСР
ДИПЛЕКС HSV I+II-TwoStep-PB-96
Хранить при температуре +2 °С
Транспортировать при температуре +2 °С
Только для in vitro диагностики

www.lytech.ru • (495) 258-39-47

научно-производственная фирма
Литех

№ серии : 01/TS-530/18
Годен до 20.03.19

ПАМЯТКА
по применению набора реагентов для выявления
HSV type 1 и HSV type 2
методом полимеразной цепной реакции с детекцией
ДНПЛЕКС HSV-nB
для диагностики in vitro

1. Подготовка к проведению амплификации нуклеиновых кислот.
 - 1.1. Приготовить необходимое число биопорций ил. ваточной пробирки для исследовательского и контрольного.
 - 1.2. Поместить в пробирку на крышке все компоненты набора реагентов. Для всех остальных пробирок на крышке отсутствуют. В таком случае в комплектности с набором подготовленных смесей и реактивов тщательно перемешать.
 - 1.3. Из компонентов набора приготовить смесь.

Рекомендуем
применять
наконечники
1.4. Перемешивание
1.5. Внесение
амплификацию
Перейти к 1

Номер серии набора 01/TS-330/18 Дата изготовления 20.06.18 Годен до 20.09.19
Номер серии ПКО ИППП СН/18 Дата изготовления 15.08.18 Годен до 15.08.20

ПКО ИППП представляет собой количественно охарактеризованную смесь калибраторов, содержащих фрагменты ДНК HSV type 1, HSV type 2, и человека.

Наименование калибратора	Концентрация (г/мл)	Допустимый диапазон Ct
HSV type 1	$2,30 \cdot 10^3$	22,6 - 26,6
HSV type 2	$4,50 \cdot 10^3$	24,0 - 28,0
ДНК человека	$9,5 \cdot 10^3$	22,1 - 26,1

СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционная смесь РВ-ТБ — 50 пробирок по 21 мкл
 2. ПКО ИППП — 1 пробирка 100 мкл
 3. Реактивы — 1 пробирка 1 мл
 4. Реактор Таргет-Систем — 1 пробирка 500 мкл
- 4 стр. 01/TS-330/18
Дата изд. 20.03.18



НАБОР РЕАГЕНТОВ для выявления в клинических
образцах ДНК HSV type 1 и HSV type 2

методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени
«ДНПЛЕКС HSV 1-2»
для диагностики in vitro по ТУ 11.001.001-001-001-001-001

ДНПЛЕКС HSV 1-2-TarGet-System-RB-96

разработано ООО ИППП «Ланет», Москва 119425, ул. Мухоморова д. 1, тел. 4993 258-
01/TS-330/18 Дата изготовления 20.06.18 Наборов в коробе 32

Данные	Единица измерения	Величина
м. смесь РВ-ТБ	50 пробирок по 21 мкл	Продукция биологической жидкости для пробирки белая, вязкая
П	1 пробирка — 100 мкл	Продукция биологической жидкости белая, вязкая
реактивы	1 пробирка — 100 мкл	Продукция биологической жидкости белая, вязкая
реактор	1 пробирка — 500 мкл	Продукция биологической жидкости белая, вязкая

Имя пациента	Характеристики и номера по ТУ	Результаты контроля
См. пункт 1.4. ТУ		Содержимое набора: - набор реагентов; - смесь для приготовления набора; - реактивы и реактор ПКО ИППП.
См. пункт 1.5. ТУ		Содержимое набора: - Реакционная смесь РВ-ТБ (реактивы) в пробирке по 21 мкл; - ПКО ИППП (реактивы) в пробирке по 100 мкл; - Реактивы, реактор Таргет-Систем и ПКО ИППП (реактивы) в пробирке по 100 мкл; - Реактор Таргет-Систем (реактив) в пробирке по 500 мкл; - Комплектация набора, включая, помимо прочего, упаковку и коробку из картона.
См. пункт 1.5. ТУ		Содержимое набора: - На каждый компонент набора, включая, помимо прочего, упаковку и коробку из картона, наклеены этикетки согласно п. 1.5.1. ТУ. - На смесь с пробирками реакционной смеси РВ-ТБ наклеены этикетки согласно п. 1.5.2. ТУ. - На потребительскую упаковку каждого набора наклеены этикетки согласно п. 1.5.3. ТУ.
1000		1027
1000		1000



Начальник отдела контроля качества продукции ООО ИППП «Ланет»







Прошито, проверено,
скреплено печатью.

Количество листов

17 шт.

Директор

Наумов А.Ю.



УТВЕРЖДАЮ
 Директор ООО НПФ «Литех»
 А.Ю.Наумов
 «18» июня 2018 г.

ООО НПФ «Литех»

Набор реагентов для выявления и идентификации
HSV type 1 и HSV type 2
 методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени
ДИПЛЕКС HSV I+II
 для диагностики in vitro

по ТУ 21.20.23-530-17253567-2018

ДИПЛЕКС HSV I+II -PB-120

Маркировка набора реагентов

ООО НПФ «Литех» 119008 г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.1, стр.2 Набор реагентов для выявления и идентификации <i>HSV type 1 и HSV type 2</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС HSV I+II для диагностики in vitro ТУ 21.20.23-530-17253567-2018ФСР ДИПЛЕКС HSV I+II-PB-120 Хранить при температуре +18...+20 °С Транспортировать при температуре +2...+8 °С не более 1 суток Только для in vitro диагностики
--

СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционный смесь РВ.....1 пробирка 960 мкл
2. Таq-полимеразы.....1 пробирка 50 мкл
3. Разбавитель.....2 пробирки по 2 мл
4. ПКО ИППН.....1 пробирка 200 мкл

№ серии : 01/530/18
 годен до : 18.06.19

Серия 01/530/18
 Годен до: 18.06.19

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ «Литех» 119008 г. Москва, ул. Малая Пироговская, д.1, стр.2 Набор реагентов для выявления и идентификации <i>HSV type 1 и HSV type 2</i> методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС HSV I+II для диагностики in vitro ТУ 21.20.23-530-17253567-2018ФСР ДИПЛЕКС HSV I+II-PB-120 Хранить при температуре +18...+20 °С Транспортировать при температуре +2...+8 °С не более 1 суток Только для in vitro диагностики
--

СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционный смесь РВ.....1 пробирка 960 мкл
2. Таq-полимеразы.....1 пробирка 50 мкл
3. Разбавитель.....2 пробирки по 2 мл
4. ПКО ИППН.....1 пробирка 200 мкл

Серия 01/530/18
 Годен до: 18.06.19

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ «Литех» Реакционная смесь 960 мкл использовать для приготовления мультиплексной смеси Серия 01/530/18 Годен до 18.06.19 Хранить при +18...+20 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС HSV I+II PB-120
---	----------------------------

ООО НПФ «Литех» Разбавитель 2 мл Серия 01/530/18 Годен до 18.06.19 Хранить при +18...+20 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС HSV I+II PB-120
--	----------------------------

ООО НПФ «Литех» Таq-полимераза 50 мкл Серия 01/530/18 Годен до 18.06.19 Хранить при +18...+20 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС HSV I+II PB-120
---	----------------------------

ООО НПФ «Литех» ПКО ИППН 200 мкл 1 пробирка Серия 01/530/18 Годен до 18.06.19 Хранить при +18...+20 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС HSV I+II PB-120
--	----------------------------

ООО НПФ «Литех» ПКО ИППН 200 мкл Серия 01/530/18 Годен до 18.06.19 Хранить при +18...+20 °С Только для in vitro диагностики	ДИПЛЕКС HSV I+II PB-120
--	----------------------------

ДИПЛЕКС HSV I+II -OneStep-PB-60

Маркировка набора реагентов

ООО ЦИРМИ "Литва"
119438 г. Москва ул. Малая Пятницкая д.1, стр.1
Набор реагентов для выявления и идентификации HSV type 1 и HSV type 2 методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС HSV I+II для диагностики in vitro
ТУ 21 20 23-530-17253567-2018ФСР
ДИПЛЕКС HSV I+II-OneStep-PB-60
Хранить при температуре 18 - 20 °С Транспортировать при температуре -2 - 8 °С не более 1 суток Только для in vitro диагностики

СОСТАВ НАБОРА

1. Амплификационная смесь PB-OS.....
60 пробирок по 20 мкл
2. ПКО ИПП1 пробирка 100 мкл
3. Разбавитель.....1 пробирка 1 мл

№ серии : 02/OS-530/18
годен до : 18.10.18

Серия : 02/OS-530/18
Годен до : 18.10.18

Маркировка внутренней упаковки

ООО ЦИРМИ "Литва"
Разбавитель
1 мл
1 пробирка
Серия 02/OS-530/18
Годен до 18.10.18
Хранить при 18 - 20 °С
Только для in vitro диагностики

ООО ЦИРМИ "Литва"
ПКО ИПП
100 мкл
1 пробирка
Серия 02/OS-530/18
Годен до 18.10.18
Хранить при 18 - 20 °С
Только для in vitro диагностики

Маркировка компонентов набора

ООО ЦИРМИ "Литва"
Разбавитель
1 мл
Серия 02/OS-530/18
Годен до 18.10.18
Хранить при 18 - 20 °С
Только для in vitro диагностики

ООО ЦИРМИ "Литва"
ПКО ИПП
100 мкл
Серия 02/OS-530/18
Годен до 18.10.18
Хранить при 18 - 20 °С
Только для in vitro диагностики

ДИПЛЕКС HSV 1+II -OneStep-PB-96

Маркировка набора реагентов

ООО ЦИРМИ "Литекс"
119428, г. Москва, ул. Милославская д.1, стр.3
Набор реагентов для выявления и идентификации HSV type 1 и HSV type 2 методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС HSV 1+II для диагностики in vitro
ТУ 21-20-23-530-17253567-2018ФСР
ДИПЛЕКС HSV 1+II-OneStep-PB-96
Хранить при температуре -18 - 20 °С Транспортировать при температуре +2 - 8 °С не более 1 суток Только для in vitro диагностики

СОСТАВ НАБОРА

1. Амплификационная смесь PB-OS.....
96 пробирок по 28 мкл
2. ПКО ИППП.....1 пробирка 100 мкл
3. Разбавитель.....1 пробирка 1 мл

№ серии : 01/OS-530/18
годен до : 18.10.18

Серия 01/OS-530/18
Годен до: 18.10.18

Маркировка внутренней упаковки

ООО ЦИРМИ "Литекс"
Разбавитель 1 мл 1 пробирка
Серия 01/OS-530/18 Годен до 18.10.18 Хранить при -18 - 20 °С Только для in vitro диагностики

ООО ЦИРМИ "Литекс"
ПКО ИППП 100 мкл 1 пробирка
Серия 01/OS-530/18 Годен до 18.10.18 Хранить при -18 - 20 °С Только для in vitro диагностики

Маркировка компонентов набора

ООО ЦИРМИ "Литекс"
Разбавитель 1 мл
Серия 01/OS-530/18 Годен до 18.10.18 Хранить при -18 - 20 °С Только для in vitro диагностики

ООО ЦИРМИ "Литекс"
ПКО ИППП 100 мкл
Серия 01/OS-530/18 Годен до 18.10.18 Хранить при -18 - 20 °С Только для in vitro диагностики

ДИПЛЕКС HSV I+II -TwoStep-PB-60

Маркировка набора реагентов

ООО НПФ "Литех" 115438, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 1, стр. 2 Набор реагентов для выявления и идентификации HSV type 1 и HSV type 2 методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС HSV I+II для диагностики in vitro ТУ 21 20 23-530-17253587-2018ФСР ДИПЛЕКС HSV I+II-TwoStep-PB-60 Хранить при температуре +2...8 °С Транспортировать при температуре +2...8 °С Только для in vitro диагностики

СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционная смесь PB-TS.....
..... 60 пробирок по 21 мкл
2. ПКО ИППП.....1 пробирка 100 мкл
3. Разбавитель.....1 пробирка 1 мл
4. Раствор Taq-полимеразы.....
..... 1 пробирка 500 мкл

№ серии : 02/TS-530/18
Годен до 20.03.19

Серия 02/TS-530/18
Годен до 20.03.19

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ "Литех" ДИПЛЕКС HSV I+II-TwoStep-PB-60 Реакционная смесь PB-TS 60 пробирок по 21 мкл Для приготовления амплификационной смеси добавить реагент Taq-полимеразы согласно инструкции Серия 02/TS-530/18 Годен до 20.03.19 Хранить при +2...8 °С Только для in vitro диагностики
--

ООО НПФ "Литех" Разбавитель 1 мл 1 пробирка Серия 02/TS-530/18 Годен до 20.03.19 Хранить при +2...8 °С Только для in vitro диагностики
--

ООО НПФ "Литех" ПКО ИППП 100 мкл 1 пробирка Серия 02/TS-530/18 Годен до 20.03.19 Хранить при +2...8 °С Только для in vitro диагностики
--

ООО НПФ "Литех" Раствор Taq-полимеразы 500 мкл 1 пробирка Серия 02/TS-530/18 Годен до 20.03.19 Хранить при +2...8 °С Только для in vitro диагностики
--

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех" Разбавитель 1 мл Серия 02/TS-530/18 Годен до 20.03.19 Хранить при +2...8 °С Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех" ПКО ИППП 100 мкл Серия 02/TS-530/18 Годен до 20.03.19 Хранить при +2...8 °С Только для in vitro диагностики

ООО НПФ "Литех" Раствор Taq-полимеразы 500 мкл Серия 02/TS-530/18 Годен до 20.03.19 Хранить при +2...8 °С Только для in vitro диагностики

ДИПЛЕКС HSV I+II -TwoStep-PB-96

Маркировка набора реагентов

ООО НПФ "Литех"
119035 г. Москва, ул. Мухоморова д.1, стр.2
Набор реагентов для выявления и идентификации HSV type 1 и HSV type 2 методом полимеразной цепной реакции с детекцией в реальном времени ДИПЛЕКС HSV I+II для диагностики ИЛ ВИЧ
ТУ 21.20.23.530-17253587-2018ФСР
ДИПЛЕКС HSV I+II-TwoStep-PB-96
Хранить при температуре +2...8 °С Транспортировать при температуре +2...8 °С Только для ИЛ ВИЧ диагностики

СОСТАВ НАБОРА

1. Реакционная смесь PB-TS.....
..... 96 пробирок по 21 мкл
2. ПКО ИППП.....1 пробирка 100 мкл
3. Разбавитель.....1 пробирка 1 мл
4. Раствор Taq-полимеразы.....
..... 1 пробирка 800 мкл

Серия 01/TS-530/18
Годен до 20.03.19

№ серии : 01/TS-530/18
Годен до 20.03.19

Маркировка внутренней упаковки

ООО НПФ "Литех"
ДИПЛЕКС HSV I+II-TwoStep-PB-96
Реакционная смесь PB-TS 96 пробирок по 21 мкл
Для приготовления аналитической смеси добавить раствор Taq-полимеразы согласно инструкции
Серия 01/TS-530/18 Годен до 20.03.19
Хранить при +2...8 °С Только для ИЛ ВИЧ диагностики

ООО НПФ "Литех"
Разбавитель 1 мл
1 пробирка
Серия 01/TS-530/18 Годен до 20.03.19
Хранить при +2...8 °С Только для ИЛ ВИЧ диагностики

ООО НПФ "Литех"
ПКО ИППП 100 мкл
1 пробирка
Серия 01/TS-530/18 Годен до 20.03.19
Хранить при +2...8 °С Только для ИЛ ВИЧ диагностики

ООО НПФ "Литех"
Раствор Taq-полимеразы 800 мкл
1 пробирка
Серия 01/TS-530/18 Годен до 20.03.19
Хранить при +2...8 °С Только для ИЛ ВИЧ диагностики

Маркировка компонентов набора

ООО НПФ "Литех"
Разбавитель 1 мл
Серия 01/TS-530/18 Годен до 20.03.19
Хранить при +2...8 °С Только для ИЛ ВИЧ диагностики

ООО НПФ "Литех"
ПКО ИППП 100 мкл
Серия 01/TS-530/18 Годен до 20.03.19
Хранить при +2...8 °С Только для ИЛ ВИЧ диагностики

ООО НПФ "Литех"
Раствор Taq-полимеразы 800 мкл
Серия 01/TS-530/18 Годен до 20.03.19
Хранить при +2...8 °С Только для ИЛ ВИЧ диагностики

Набор реагентов для выявления и идентификации

HSV type 1 HSV type 2

методом полимеразной цепной реакции
с детекцией в реальном времени

ДИПЛЕКС HSV I+II

для диагностики *in vitro*

ДИПЛЕКС HSV I+II-PB-120

Номер серии 01/530/18

Дата изготовления 18.06.2018

Годен до 18.06.2019

Число единиц потребительской упаковки _____

Масса нетто _____

Масса Брутто _____

Масса нетто потребительской упаковки _____

Условия хранения:

Набор **ДИПЛЕКС HSV I+II-PB-120** должен храниться при температуре минус 18-20 °С в течение всего срока годности.

Условия транспортировки:

Транспортировать при температуре от плюс 2 до 8 °С в течение 5 дней (не более).

Копия на 6 листах верна.

Директор  Наумов А.Ю.

