

- Юридический адрес:
117246, г. Москва, Пр-д Научный, д. 20 стр. 2,
- Почтовый адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе,
- +7 (495) 190-00-05
- Info@expressm-test.ru
- <https://expressm-test.ru/>

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиЛабТест»

ОГРН: 1157746600153 ИНН/КПП 7728277709/772801001

№ от 03.02.2023

Генеральный директор ООО «ПРОФИЛАБТЕСТ»

А.И. Киреев



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени

«Activated Partial Thromboplastin Time Reagent Kit»

производства

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. (Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко, Лтд.)


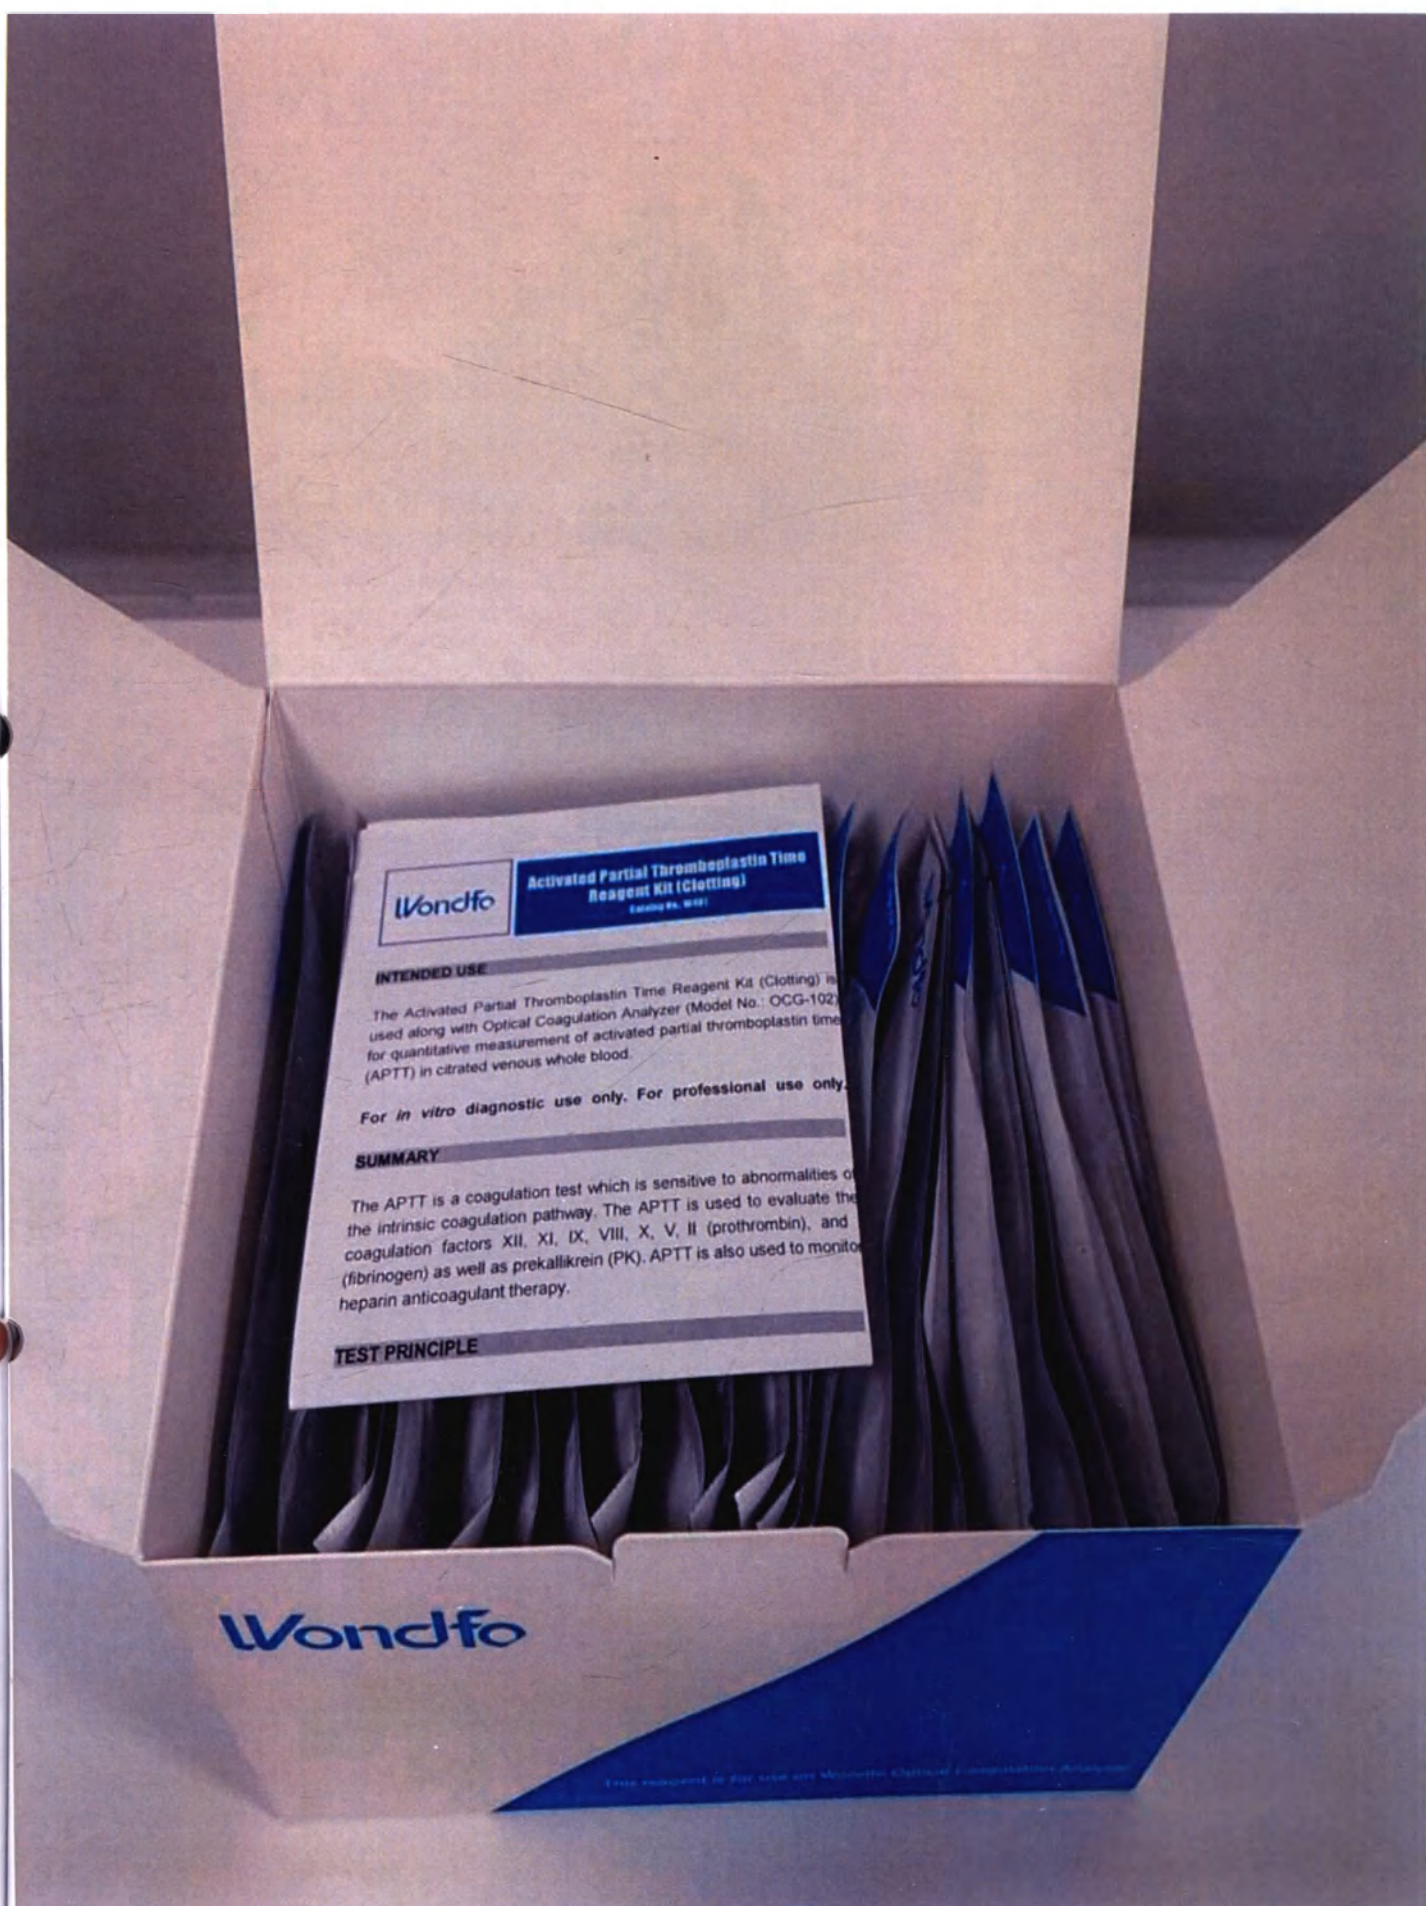


Рисунок 1. Фотографическое изображение медицинского изделия «Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени «Activated Partial Thromboplastin Time Reagent Kit»», содержимое вскрытой групповой упаковки.

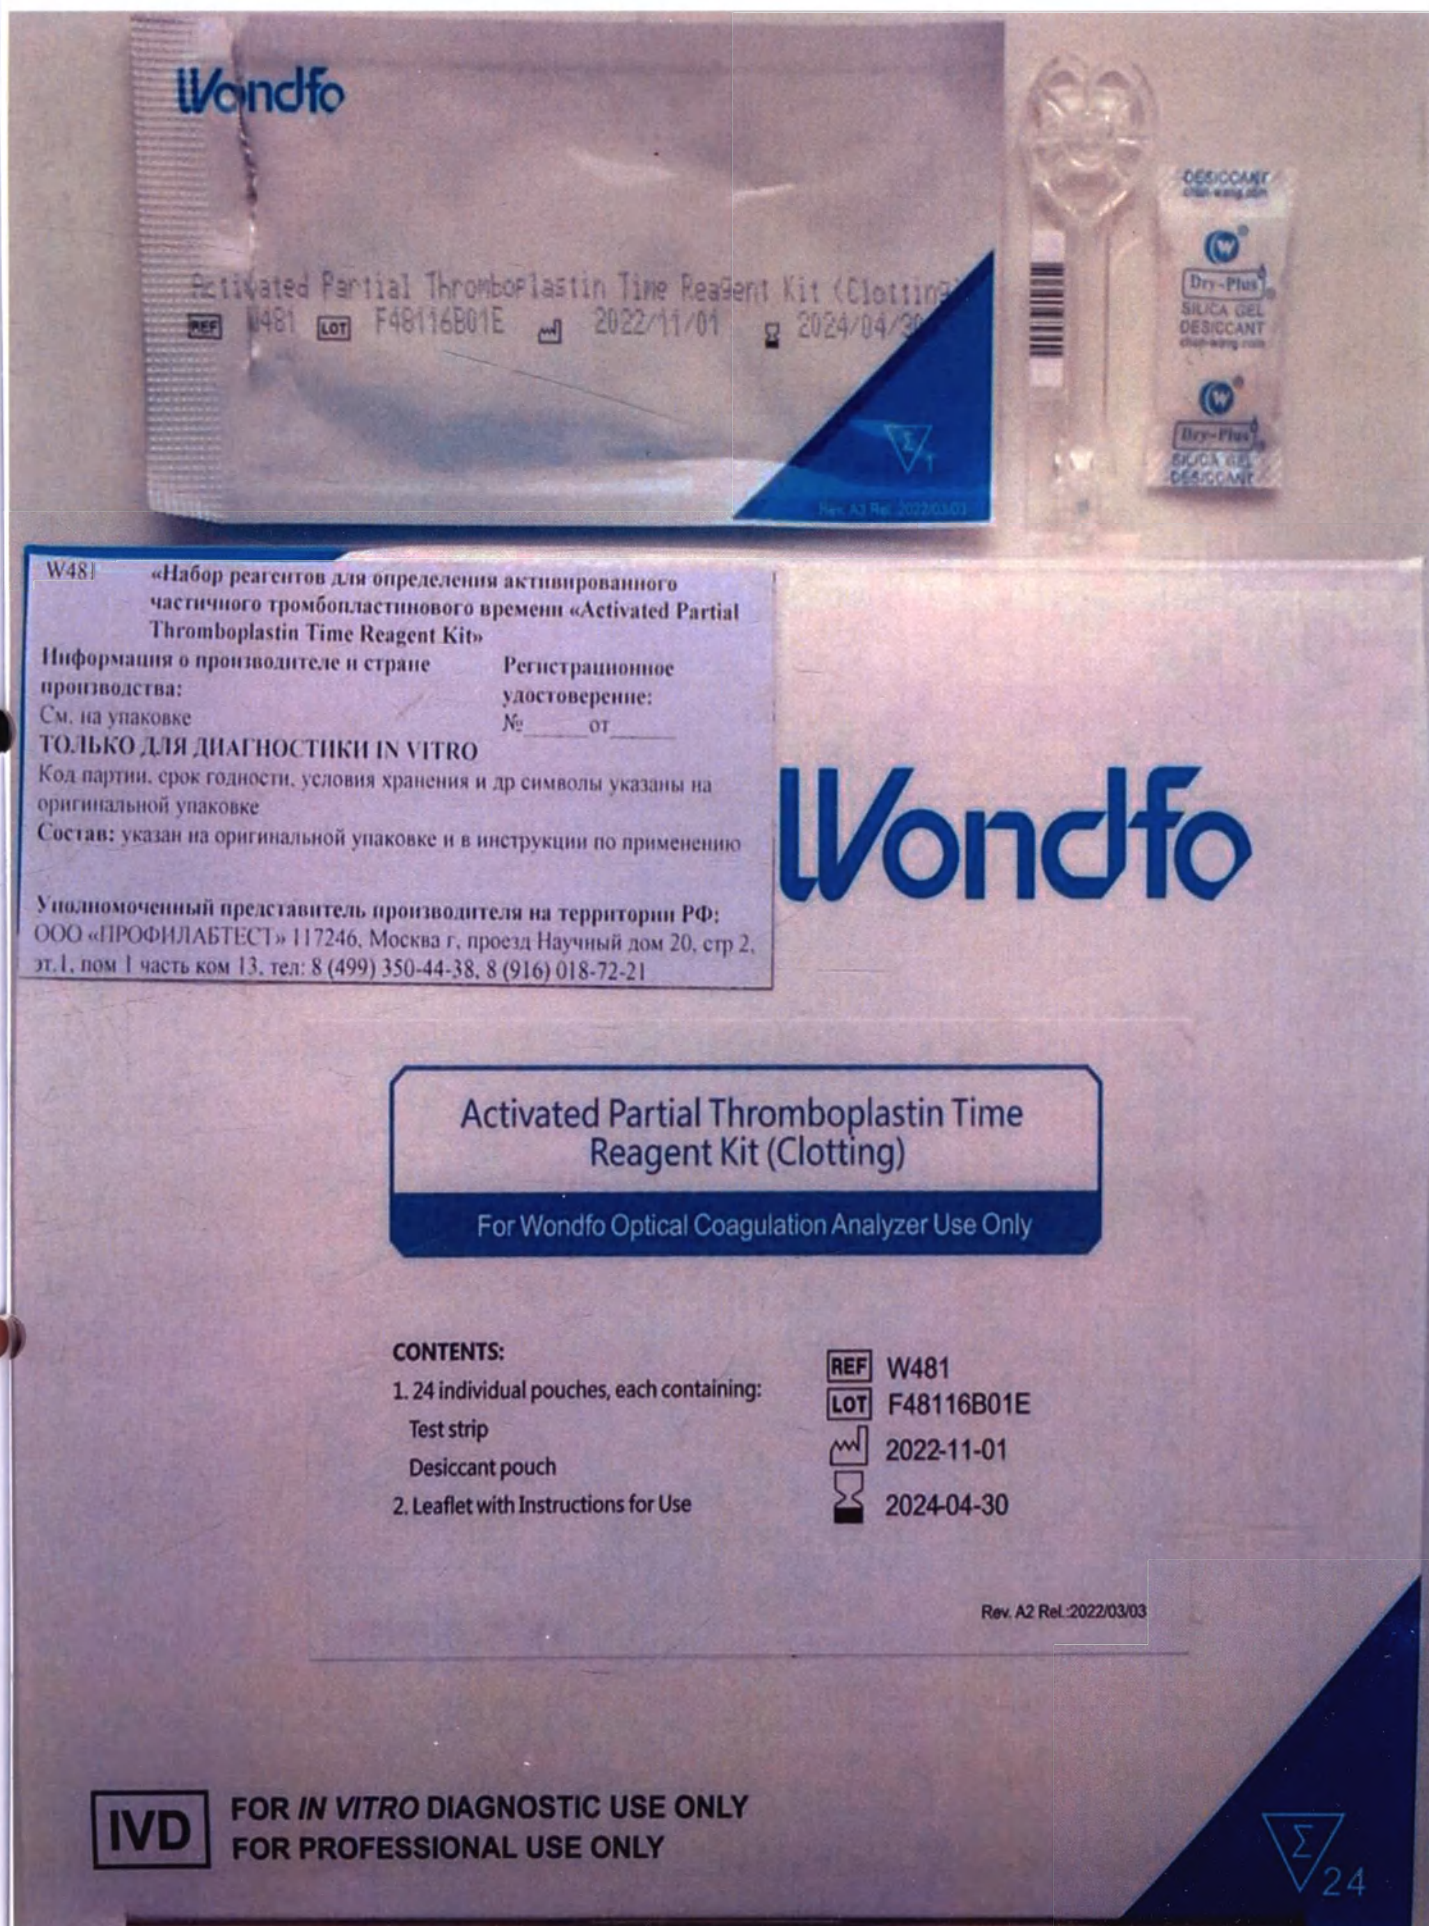

W481 «Набор реагентов для определения активированного
частичного тромбопластинового времени «Activated Partial
Thromboplastin Time Reagent Kit»

Информация о производителе и стране
производства:

См. на упаковке

Регистрационное
удостоверение:

№ _____ от _____

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др символы указаны на
оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «ПРОФИЛАБТЕСТ» 117246, Москва г, проезд Научный дом 20, стр 2,
эт.1, пом 1 часть ком 13, тел: 8 (499) 350-44-38, 8 (916) 018-72-21

Activated Partial Thromboplastin Time Reagent Kit (Clotting)

For Wondfo Optical Coagulation Analyzer Use Only

CONTENTS:

1. 24 individual pouches, each containing:

Test strip

Desiccant pouch

2. Leaflet with Instructions for Use

REF W481

LOT F48116B01E

2022-11-01

2024-04-30

Rev. A2 Rel. 2022/03/03

IVD

FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Σ
24

Рисунок 2. Фотографическое изображение медицинского изделия «Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени «Activated Partial Thromboplastin Time Reagent Kit»», маркировка групповой и первичной упаковок.

Wondfo

Activated Partial Thromboplastin Time Reagent Kit (Clotting)

REF

U481

LOT

F48116B01E

2022/11/01

2024/04/30

Rev. A3 Rel. 2022/03/03



Rev. A3 Rel. 2022/03/03

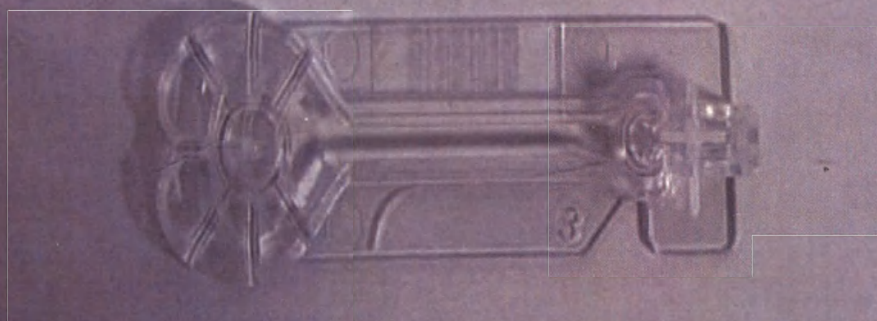


Рисунок 3. Фотографическое изображение медицинского изделия «Набор реагентов для определения активированного частичного тромбoplastинового времени «Activated Partial Thromboplastin Time Reagent Kit»», состав первичной упаковки (тест-кассета).

Всего пронумеровано и скреплено печатью

41

Генеральный директор ООО «ПРОФИЛАБТЕСТ»



А.И. Киреев

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'А.И. Киреев', written over a horizontal line.