

- Юридический адрес:
117246, г. Москва, Пр-д Научный, д. 20 стр. 2,
Почтовый адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе,
+7 (495) 190-00-05
Info@expressm-test.ru
https://expressm-test.ru/

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиЛабТест»

ОГРН: 1157746600153 ИНН/КПП 7728277709/772801001

№ от 03.02.2023

Генеральный директор ООО «ПРОФИЛАБТЕСТ»

А.И. Киреев



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор реагентов для определения фибриногена

«Fibrinogen Reagent Kit»

производства

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. (Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко, Лтд.)

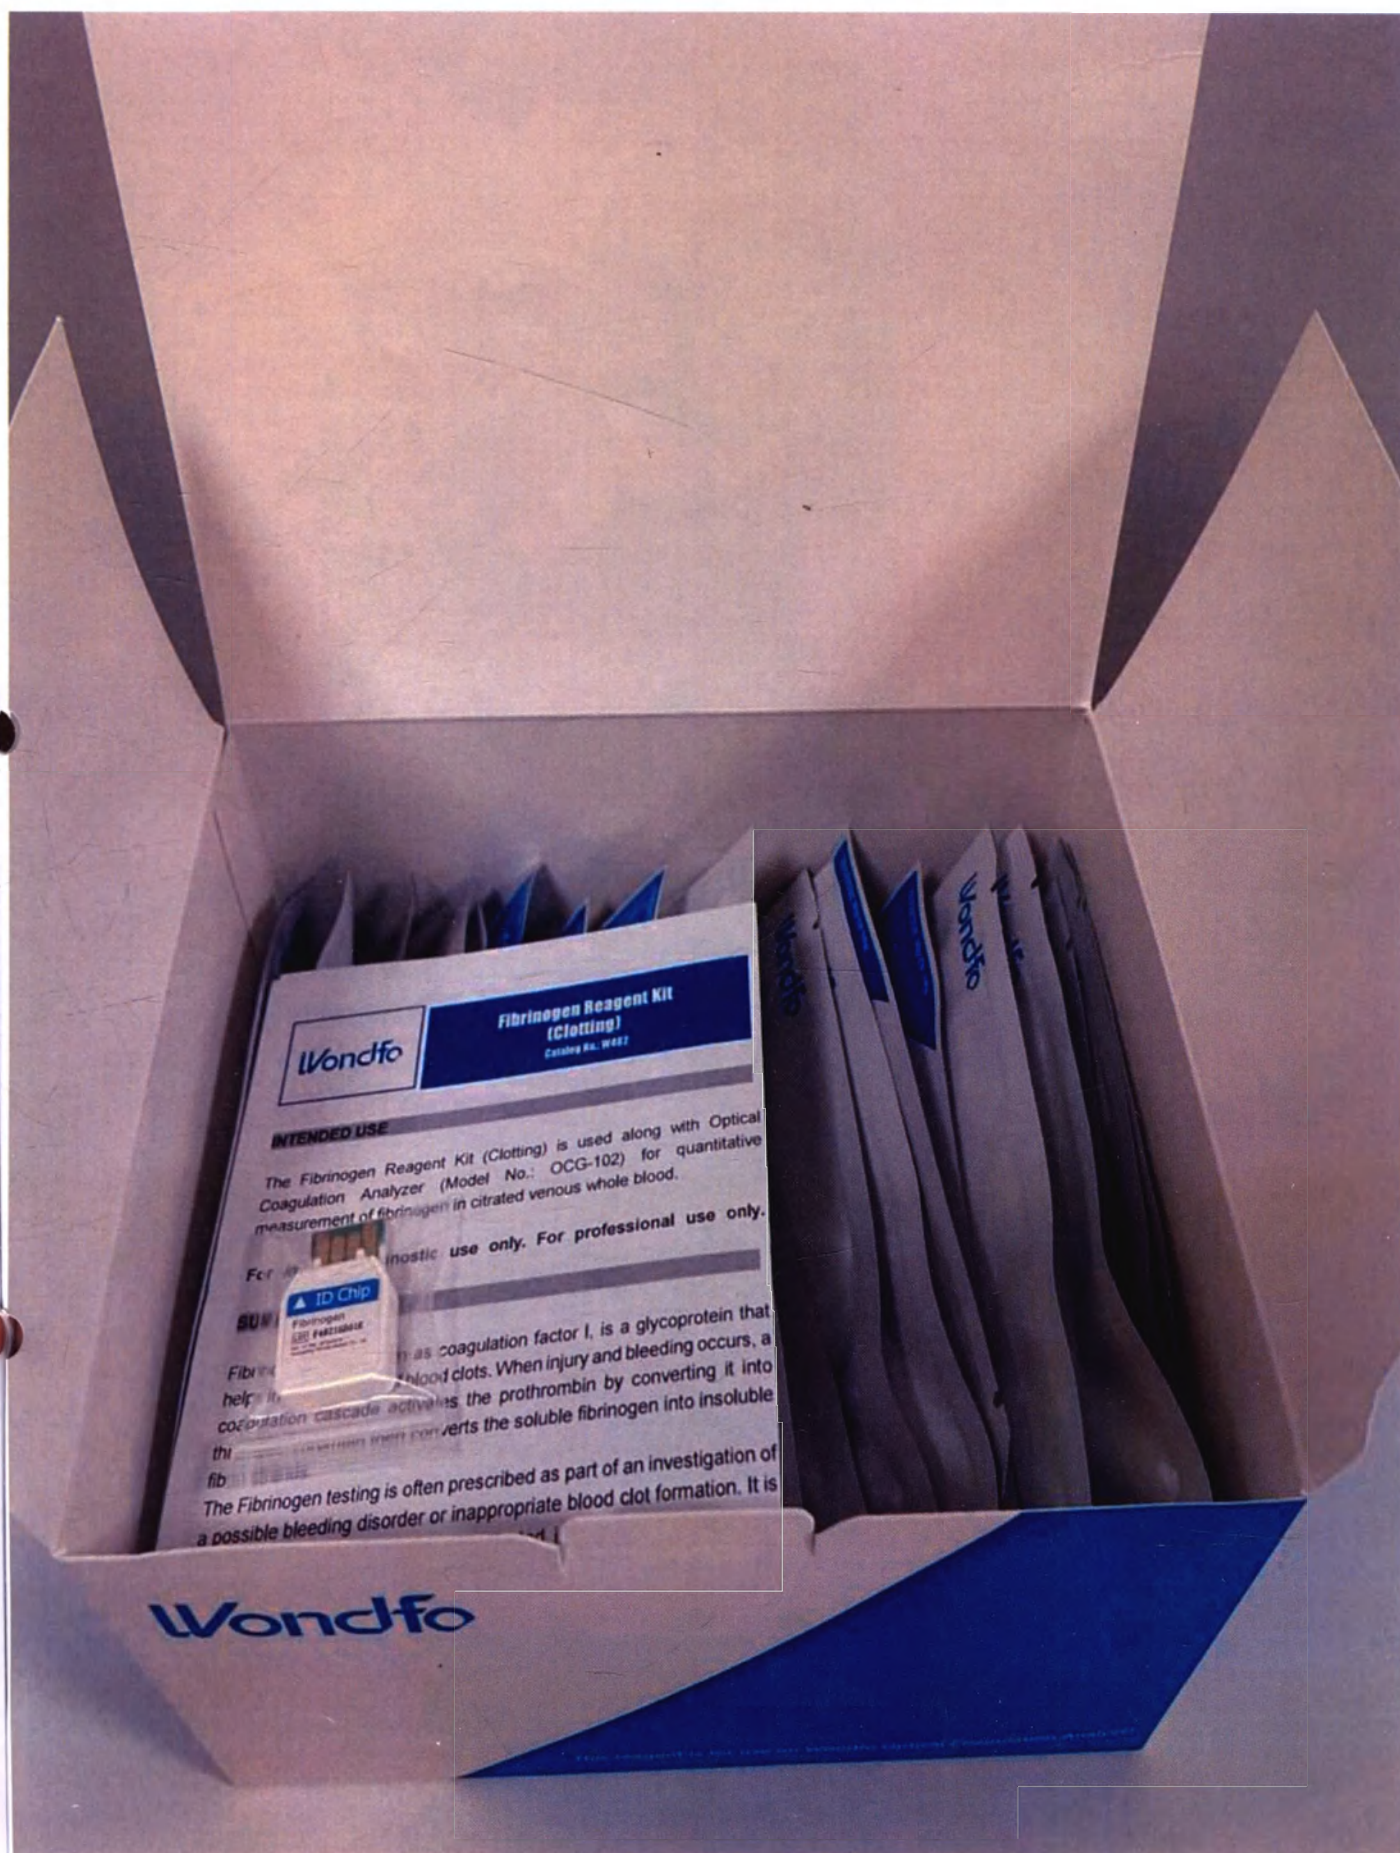


Рисунок 1. Фотографическое изображение медицинского изделия «Набор реагентов для определения фибриногена «Fibrinogen Reagent Kit»», содержимое вскрытой групповой упаковки.

Wondfo

Fibrinogen Reagent Kit (Clotting)

REF

W482

LOT

F48216B02E

EXP

2022/11/02

EXP

2024/05-01

Rev. A3 Rel: 2022/03/03

ID Chip

Fibrinogen
LOT F48216B02E

Dry-Plus
SILICA GEL
DESICCANT
shun-wang.com

Dry-Plus
SILICA GEL
DESICCANT

W482 «Набор реагентов для определения фибриногена «Fibrinogen Reagent Kit»

Информация о производителе и стране производства:

См. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ _____ от _____

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др символы указаны на оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
ООО «ПРОФИЛАБТЕСТ» 117246, Москва г. проезд Научный дом 20, стр 2,
эт. 1, пом 1 часть ком 13, тел: 8 (499) 350-44-38, 8 (916) 018-72-21

Wondfo

Fibrinogen Reagent Kit (Clotting)

For Wondfo Optical Coagulation Analyzer Use Only

CONTENTS:

1. 24 individual pouches, each containing:

Test strip

Desiccant pouch

2. ID Chip

3. Leaflet with Instructions for Use

REF

W482

LOT

F48216B02E

EXP

2022-11-02

EXP

2024-05-01

Rev. A2 Rel: 2022/03/03

IVD

FOR IN VITRO DIAGNOSTIC USE ONLY
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Σ 24

Рисунок 2. Фотографическое изображение медицинского изделия «Набор реагентов для определения фибриногена «Fibrinogen Reagent Kit»», маркировка групповой и первичной упаковок.

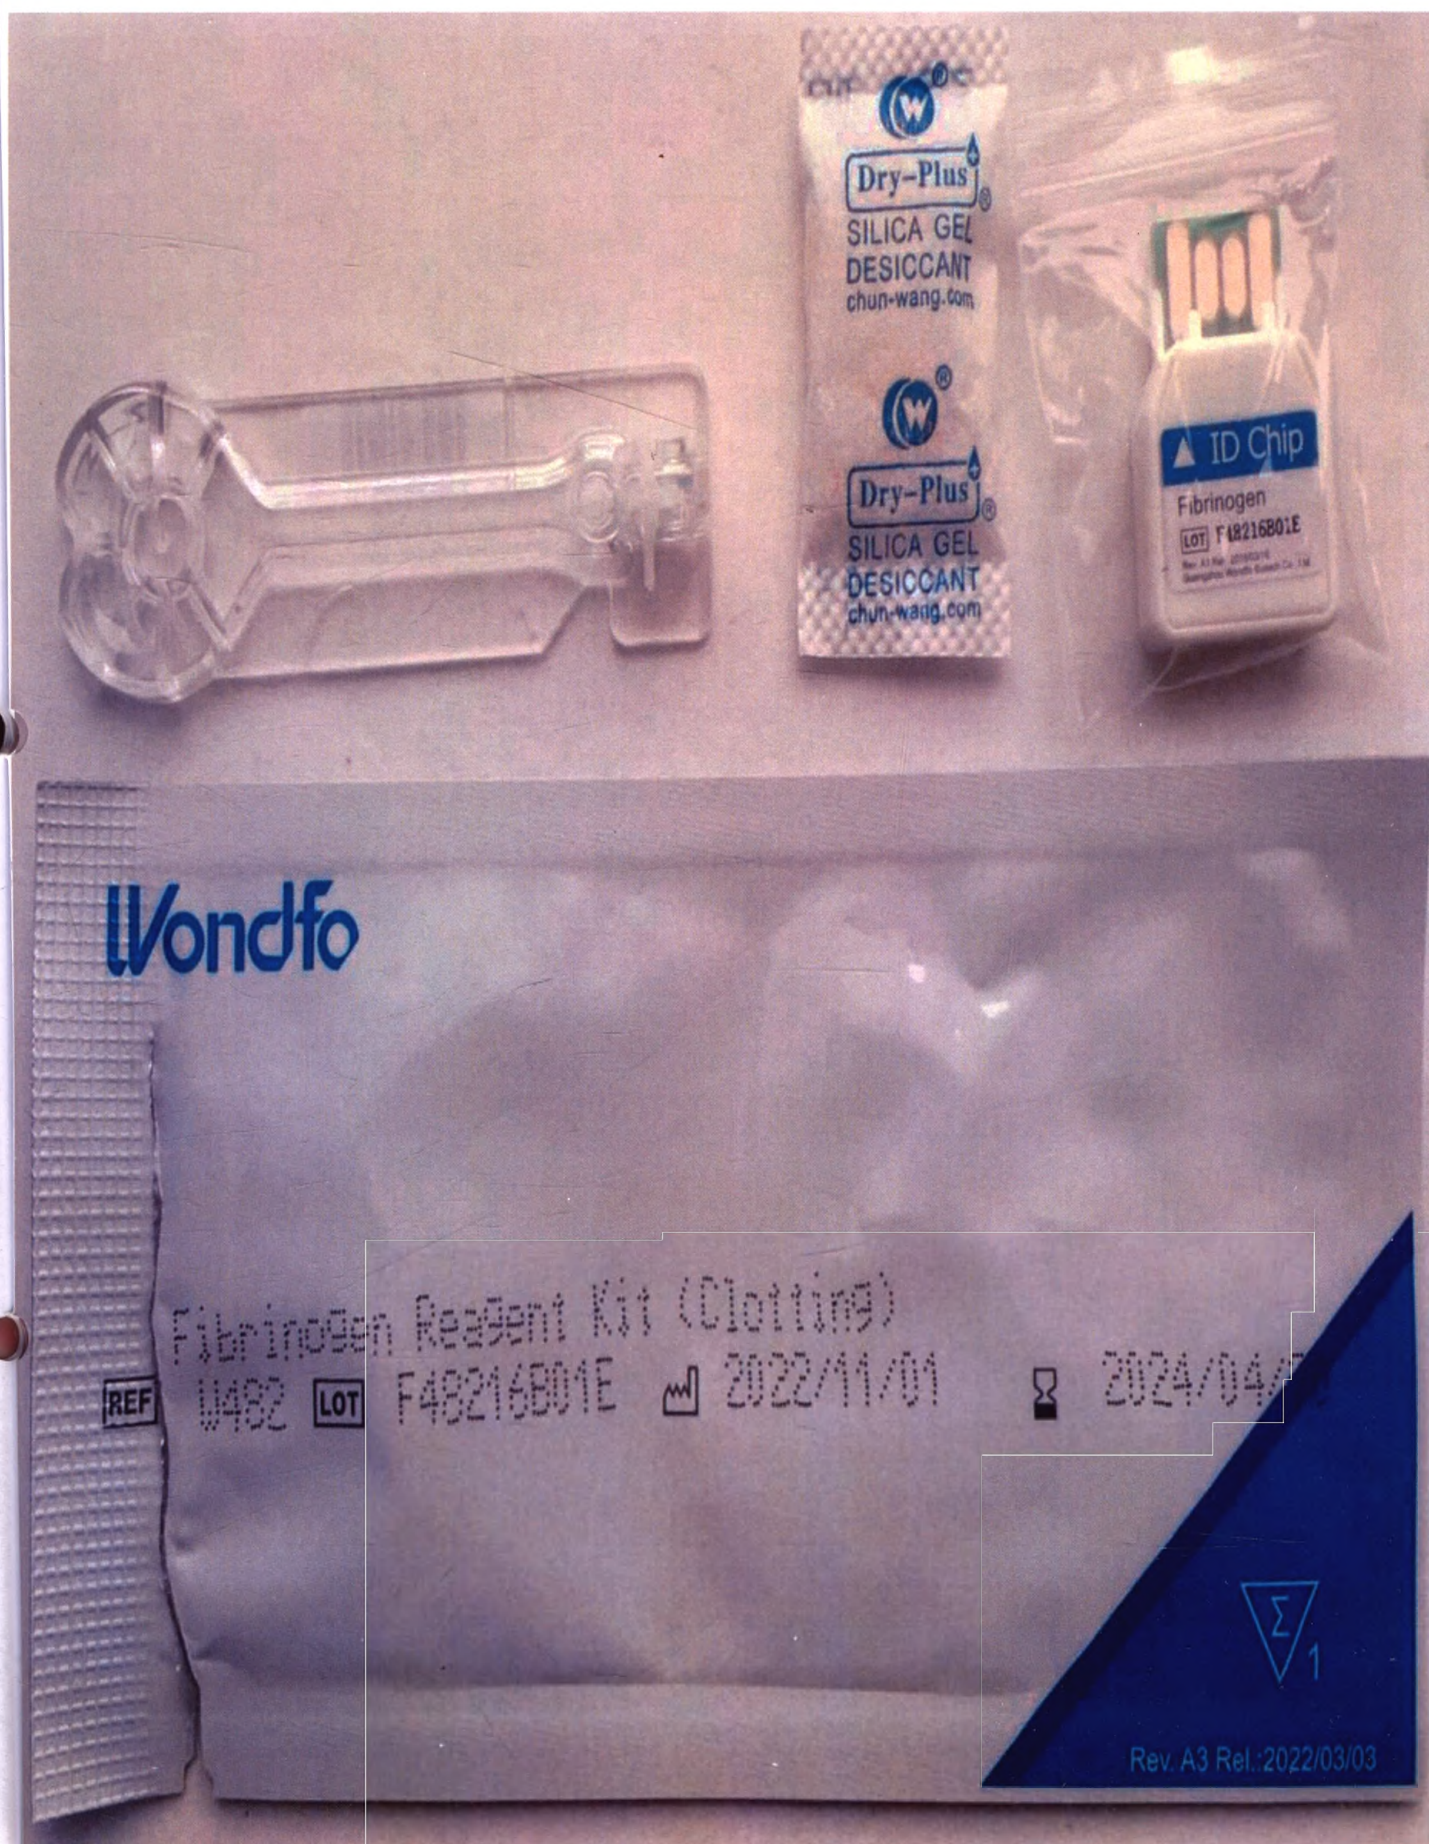


Рисунок 3. Фотографическое изображение медицинского изделия «Набор реагентов для определения фибриногена «Fibrinogen Reagent Kit»», состав первичной упаковки (тест-кассета, идентификационный чип).



Рисунок 4. Фотографическое изображение медицинского изделия «Набор реагентов для определения фибриногена «Fibrinogen Reagent Kit»» идентификационный чип.

Всего пронумеровано и скреплено печатью

Бирюков

Генеральный директор ООО «ПРОФИЛАБТЕСТ»

А.И. Киреев

Киреев

