

- Юридический адрес:
117246, г. Москва, Пр-д Научный, д. 20 стр. 2,
Почтовый адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе,
+7 (495) 190-00-05
Info@expressm-test.ru
https://expressm-test.ru/


Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиЛабТест»

ОГРН: 1157746600153 ИНН/КПП 7728277709/772801001

№ от 03.02.23

Генеральный директор ООО «ПРОФИЛАБТЕСТ»

А.И. Киреев



" 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Коагулометр оптический OCG-102»

производства

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. (Гуанчжоу Вондфо Биотех Ко, Лтд.)



Рисунок 1. Фотографическое изображение медицинского изделия «Коагулометр оптический OCG-102»

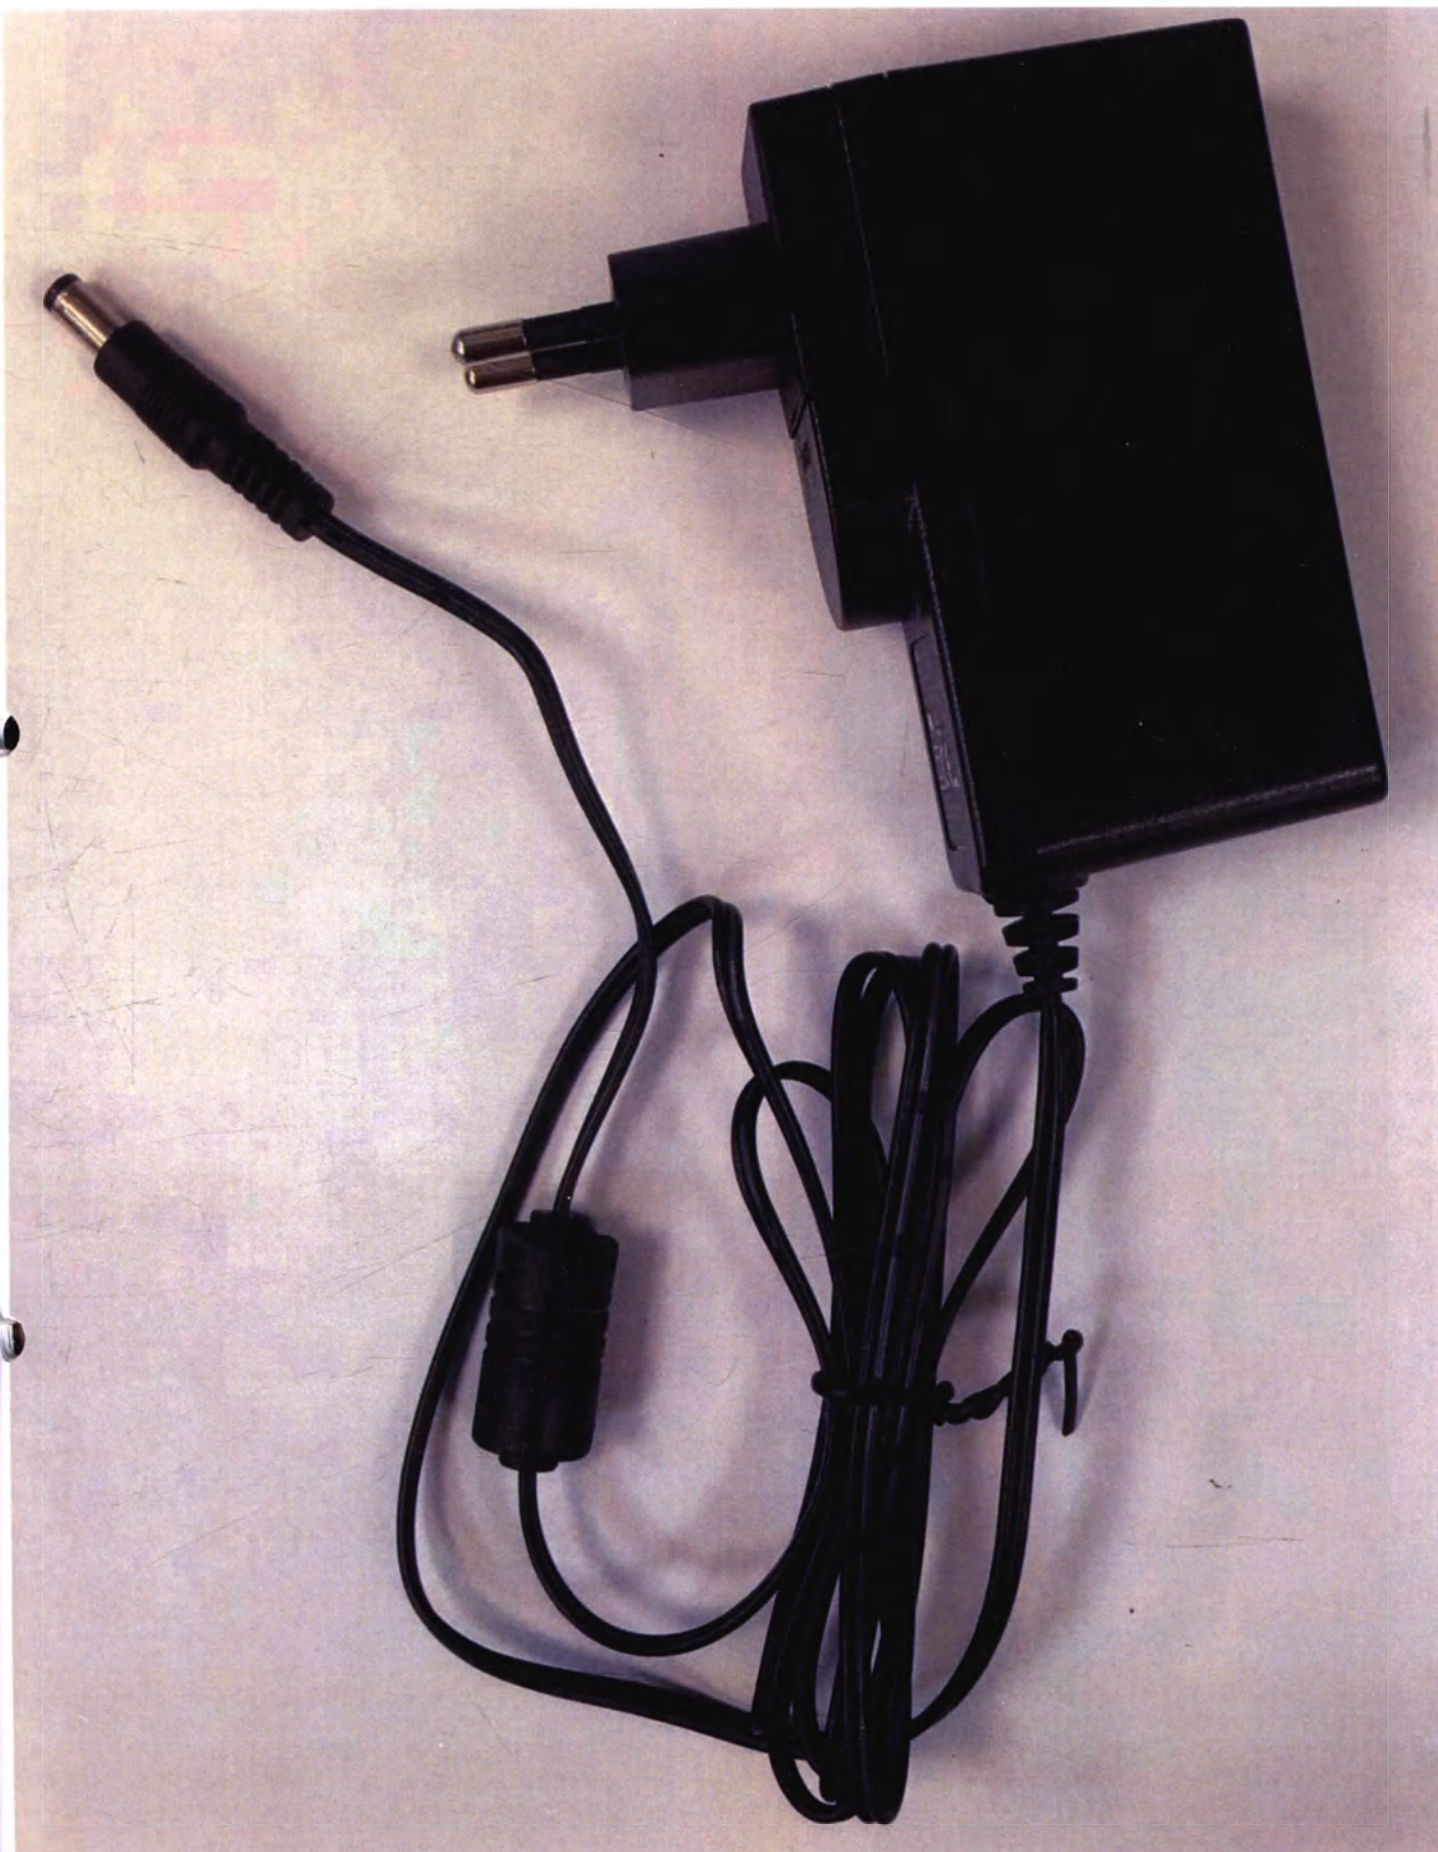


Рисунок 2. Фотографическое изображение *составляющего* медицинского изделия «Коагулометр оптический OCG-102»: Адаптер питания

Wondfo

Optical Coagulation Analyzer

Model No.: OCG-102

Operation Manual

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.

Рисунок 3. Фотографическое изображение *составляющего* медицинского изделия «Коагулометр оптический OCG-102»: Руководство пользователя

Warranty Card

Dear Users:

Sincerely thank you for using wondfo products for your rights please fill in the following information carefully. In order to provide the latest product and academic information for you, please get it back to us. If you have any questions, please contact us.

Customer information :

Customer Name		Contact Person	
Address		Tel.	
Postcode		Purchase Time	
Product Name		Model No.	
Device Catalogue No.			
Remark			

Maintenance Record:

Date	Failure Phenomenon	Failure Reason	Maintenance Status	Engineer	User Signature

Manufacturer: Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.

Address: No.8 Lizhishan Road, Science City, Luogang District, 510663, Guangzhou, P.R.China

Tel: (+86) 400-830-8768

Website: en.wondfo.com.cn

E-mail: sales@wondfo.com.cn

Rev. A3 Rel.: 2022/03/18

Рисунок 4. Фотографическое изображение *составляющего* медицинского изделия «Коагулометр оптический OCG-102»: Гарантийный талон

合格证

合格
检




Рисунок 5. Фотографическое изображение *составляющего* медицинского изделия «Коагулометр оптический OCG-102»: Сертификат качества

Wondfo Optical Coagulation Analyzer

Quick Operation Instructions for Use

(OCG-102)



1. Turn on the Wondfo Optical Coagulation Analyzer by connecting power adapter or using the two rechargeable lithium batteries.



2. Insert the test strip as shown in the image. The Coagulation Analyzer recognizes test items by scanning barcodes printed on the test strip.




3. Before starting Fibrinogen tests, insert the ID chip into the ID chip slot. Make sure the lot number shown on the screen and the reagent package match.




4. Confirm the test item, the Coagulation analyzer starts preheating automatically. The preheating lasts for 25 seconds.




5. Add blood samples into the sample well.



6. The test starts automatically after sample is added.



7. Test result is shown on the screen and stored automatically after finishing the test. Remove the used test strip manually.



8. Press the MEM button to review previous test results. Print the test results by clicking .

Rev. A1 Rel. 2018/01/10

Рисунок 6. Фотографическое изображение составляющего медицинского изделия «Коагулометр оптический OCG-102»: Краткое руководство пользователя

Wondfo Optical Coagulation Analyzer

PACKAGING LIST

Name	Quantity
Wondfo Optical Coagulation Analyzer	1
Power Adapter	1
User Manual	1
Warranty Card	1
Certificate of Approval	1
Quick Operation Instructions for Use	1
Packaging List	1
Printer	1

Rev. A3 Rel.: 2022/03/03

Рисунок 7. Фотографическое изображение *составляющего* медицинского изделия «Коагулометр оптический OCG-102»: Упаковочный лист



Рисунок 8/8.1 Фотографическое изображение *составляющего* медицинского изделия «Коагулометр оптический OCG-102»: Принтер (основной корпус)



Рисунок 8.2 Фотографическое изображение *составляющего* медицинского изделия «Коагулометр оптический OCG-102»: Принтер: Адаптер питания

聚合物锂电池

型号：HND-M07



标称电压：7.4V

标称容量：1200mAh/8.88Wh




充电限制电压：8.4V

执行标准：GB31241-2014



警告：



请使用指定的充电器充电

请勿拆解电池



请勿将电池投入火中

请勿将电池放置于过热或潮湿的环境

深圳市恒能达科技有限公司

Рисунок 8.3 Фотографическое изображение *составляющего* медицинского изделия «Коагулометр оптический OCG-102»: Принтер: Аккумулятор

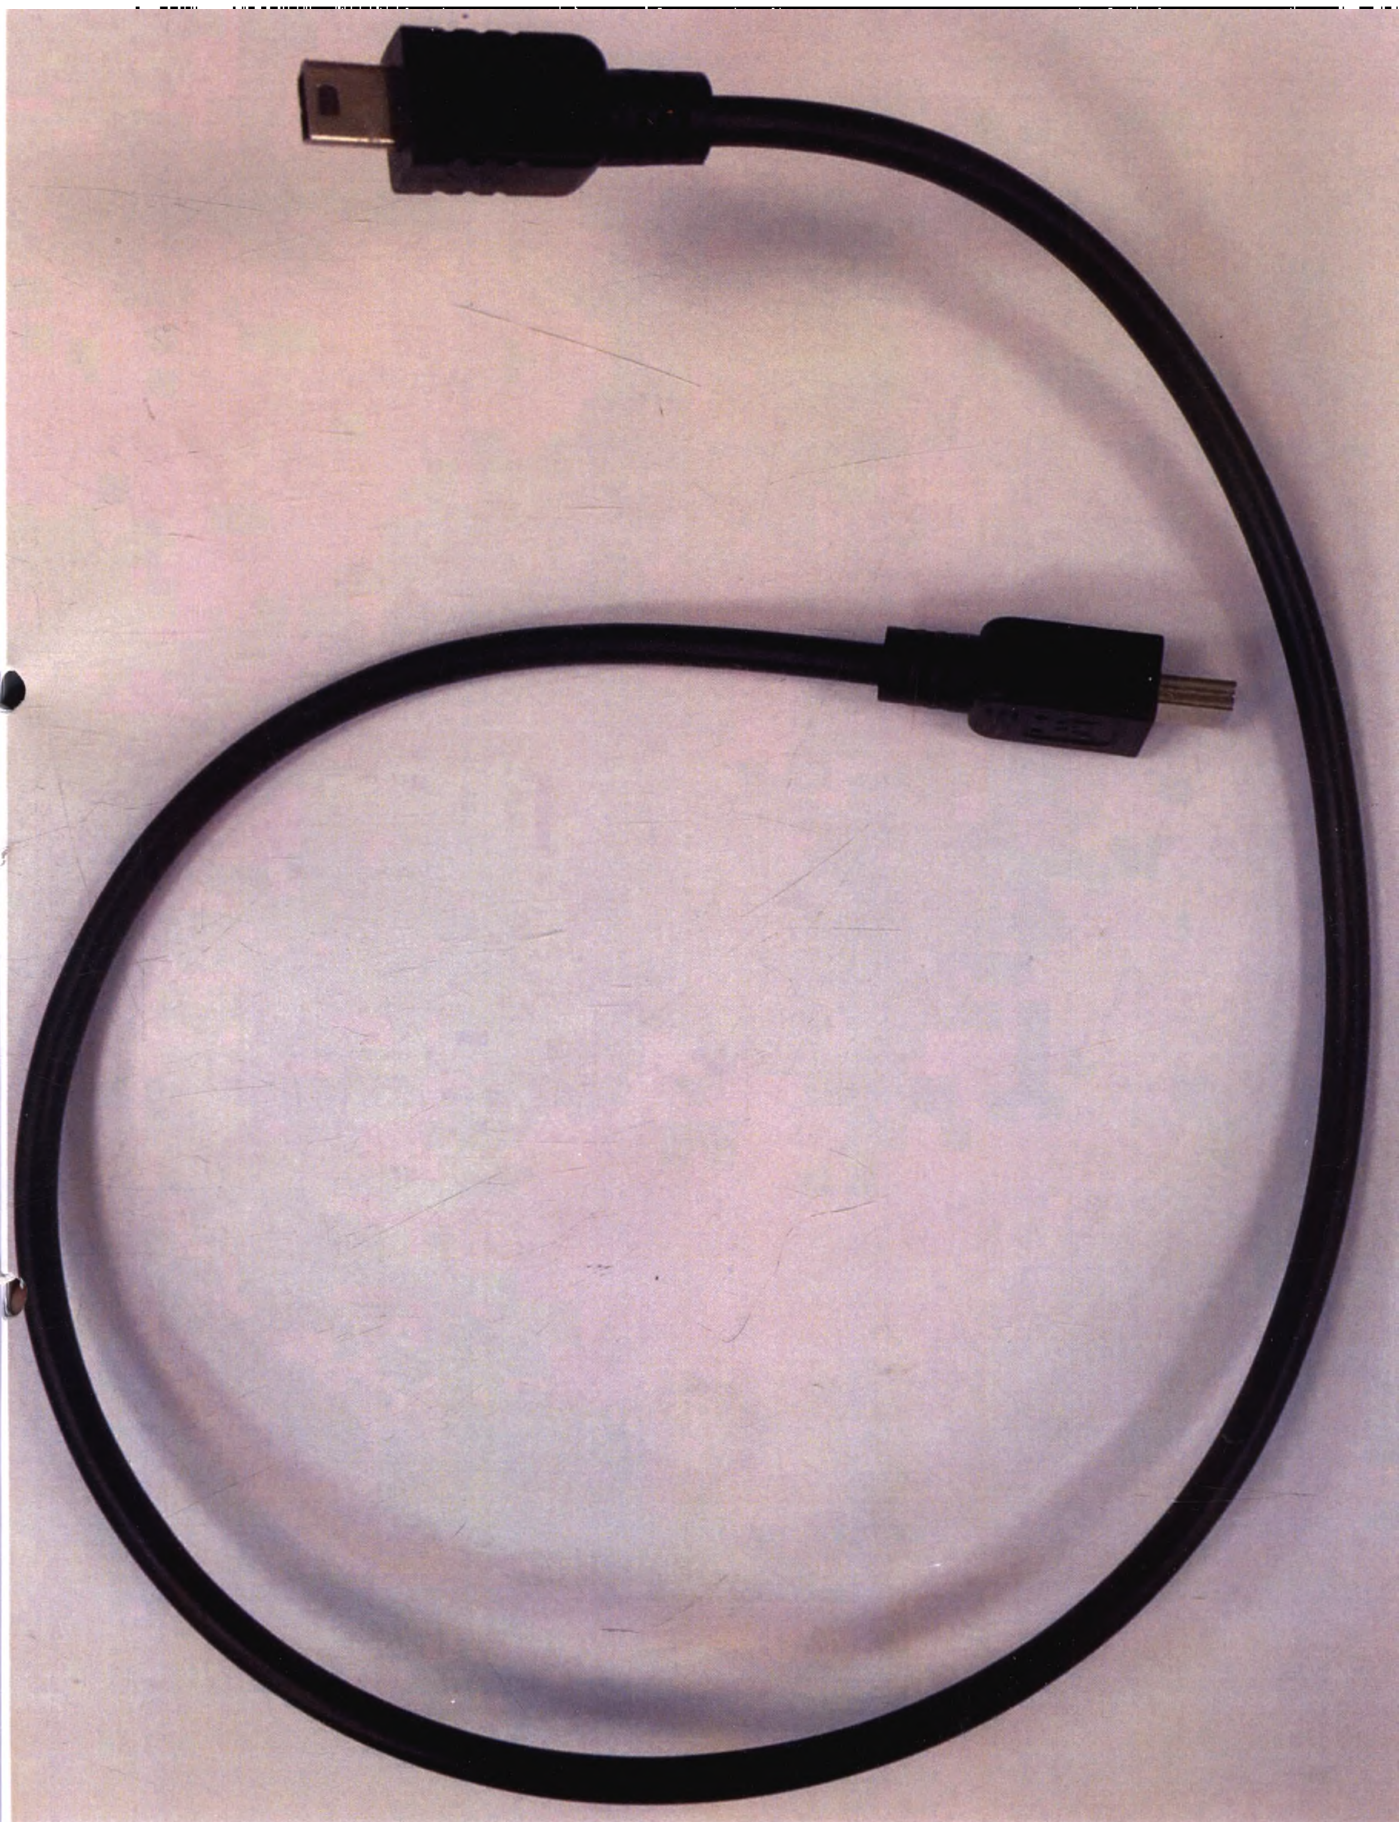


Рисунок 8.4. Фотографическое изображение составляющего медицинского изделия «Коагулометр оптический ОСГ-102»: Принтер: Кабель для передачи данных


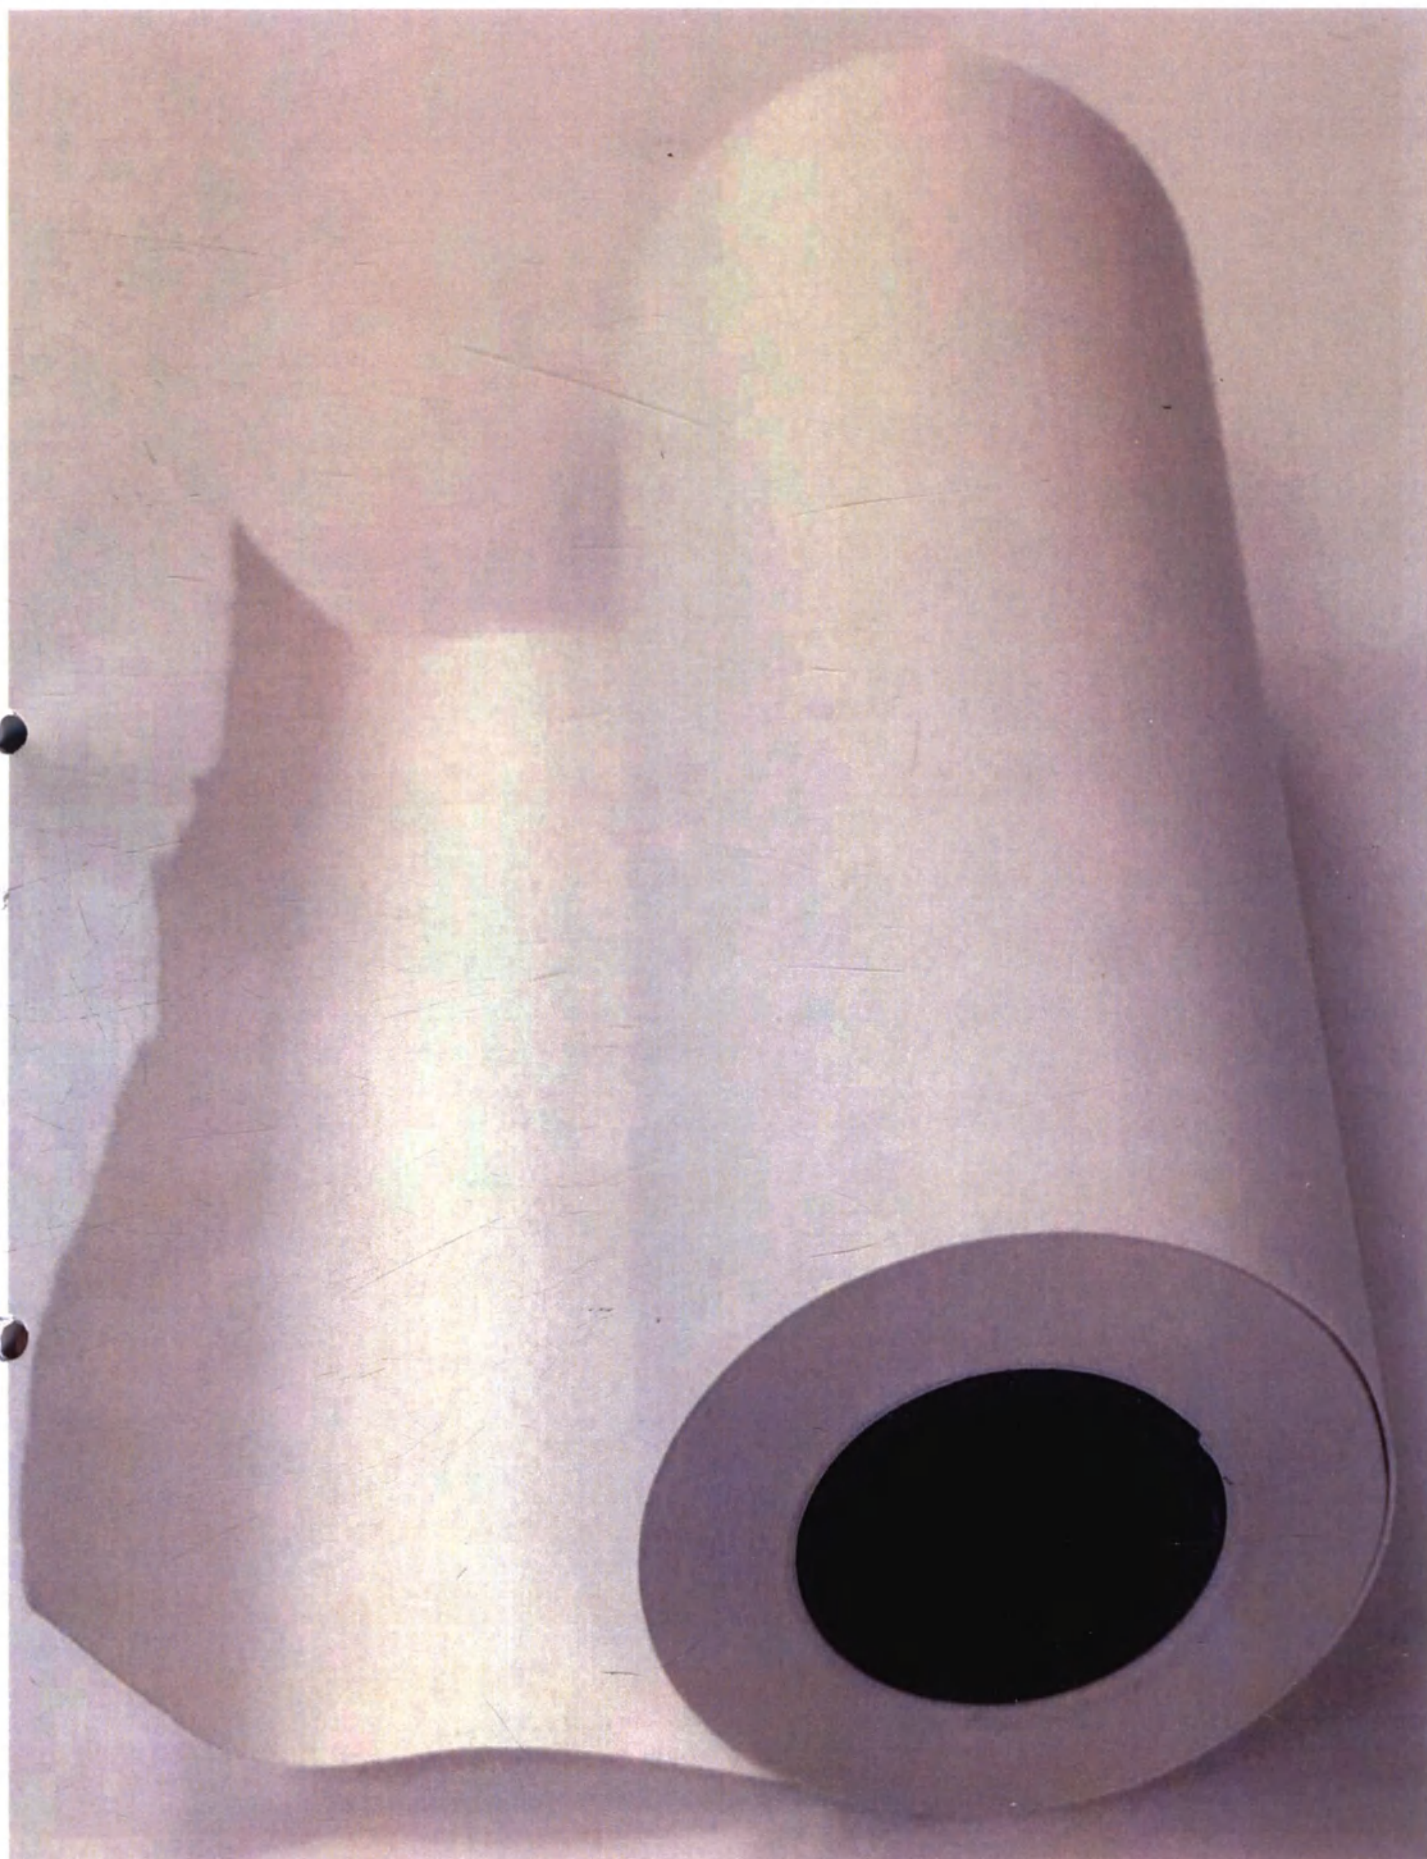


Рисунок 8.5. Фотографическое изображение составляющего медицинского изделия «Коагулометр оптический ОСГ-102»: Принтер: Бумага для термопечати

●打印机的零件——Printer Parts Manual

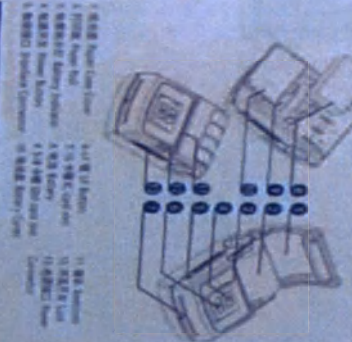

張江未來新操作

[illegible]

系统, 如图中所示, 系统 (U) 被分为两个部分, 可以打碎它。

Operational Excellence / Innovation

is the fine structure indicator β factor


seconds when the press is off. The status indicator light turns off.

slightly the bottom. It will stop feeding just

The belt test

release and power up. The battery pack will be returned to the

Ref size

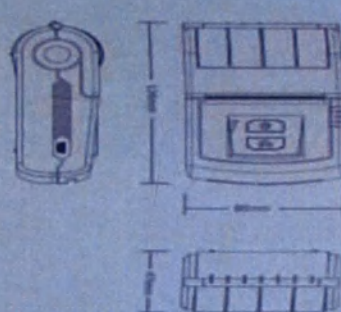


Model Size/ Product Size

0.0017 (0.01 wt % toluene)	1.46 g (0.02 mmol) (N) 147 mg
0.0017 (0.01 wt % toluene)	1.46 g (0.02 mmol) (N) 147 mg

表 2-2	表 2-3	表 2-4
Figure 2-2	Figure 2-3	Figure 2-4
Midwest	North	South
0-10-20km	0-10-20km	0-10-20km
0-10-20km	0-10-20km	0-10-20km

● 安装 Installation

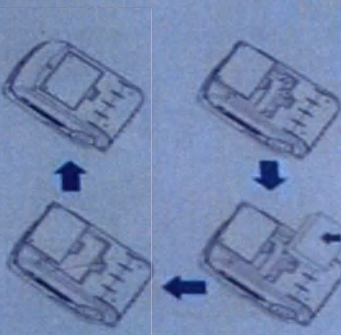


安装方法

在经历了电话、网络、短信等一系列的沟通后，在努力磨合一段时间后，电话是沟通

Installation Methods

As the article goes, with the battery more open, and with the battery less open, it will be a little more open, and with the battery more open, it will be a little more open.

● 连接 Connections

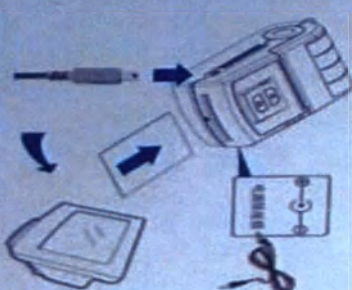

100

[illegible][illegible]

WILEY-INTERSCIENCE

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

[illegible]

... (faint text) ...

Рисунок 8.6.1 Фотографическое изображение *составляющего* медицинского изделия «Коагулометр оптический OCG-102»: Принтер: Инструкция по применению (сторона 1)

● 装纸 Paper Roll

安装步骤

1. 打开前盖，取出前盖上的纸卷。
2. 将纸卷放入打印机内部。
3. 关闭前盖，将纸卷放入打印机内部。
4. 按下纸卷按钮，将纸卷放入打印机内部。

注意事项

1. 在装入纸卷时，请确保纸卷的直径在 100mm 以内。
2. 在装入纸卷时，请确保纸卷的厚度在 0.1mm 以内。
3. 在装入纸卷时，请确保纸卷的材质为医用级聚丙烯。
4. 在装入纸卷时，请确保纸卷的宽度为 100mm。

更换纸卷 (Change Paper Roll)

1. 按图 1 所示，打开前盖，取出前盖上的纸卷。
2. 将纸卷放入打印机内部。
3. 关闭前盖，将纸卷放入打印机内部。
4. 按下纸卷按钮，将纸卷放入打印机内部。

● 清洁 Cleaning

清洁步骤

1. 打开前盖，取出前盖上的纸卷。
2. 用干净的布擦拭纸卷。
3. 关闭前盖，将纸卷放入打印机内部。

注意事项

1. 在清洁纸卷时，请确保纸卷的直径在 100mm 以内。
2. 在清洁纸卷时，请确保纸卷的厚度在 0.1mm 以内。
3. 在清洁纸卷时，请确保纸卷的材质为医用级聚丙烯。
4. 在清洁纸卷时，请确保纸卷的宽度为 100mm。

打印机清洁 (Printer Cleaning)

1. 按图 1 所示，打开前盖，取出前盖上的纸卷。
2. 用干净的布擦拭纸卷。
3. 关闭前盖，将纸卷放入打印机内部。
4. 按下纸卷按钮，将纸卷放入打印机内部。

● 产品特点

名称	特点
打印机	采用医用级聚丙烯材料，安全可靠。
纸卷	采用医用级聚丙烯材料，安全可靠。
纸卷直径	100mm
纸卷厚度	0.1mm
纸卷材质	医用级聚丙烯
纸卷宽度	100mm
纸卷长度	100mm
纸卷重量	100g
纸卷价格	100元

产品特点

1. 采用医用级聚丙烯材料，安全可靠。
2. 采用医用级聚丙烯材料，安全可靠。
3. 采用医用级聚丙烯材料，安全可靠。
4. 采用医用级聚丙烯材料，安全可靠。



北京博恩特科技有限公司
 Beijing Bontech Technology Co., Ltd.
 100000

M07/M08

快速安装

QUICK INSTALL

Рисунок 8.6.2 Фотографическое изображение составляющего медицинского изделия «Коагулометр оптический OCG-102»: Принтер: Инструкция по применению (сторона 2)

合格证

合格
檢



品质创造价值

Рисунок 8.7 Фотографическое изображение составляющего медицинского изделия «Коагулометр оптический OCG-102»: Принтер: Сертификат качества

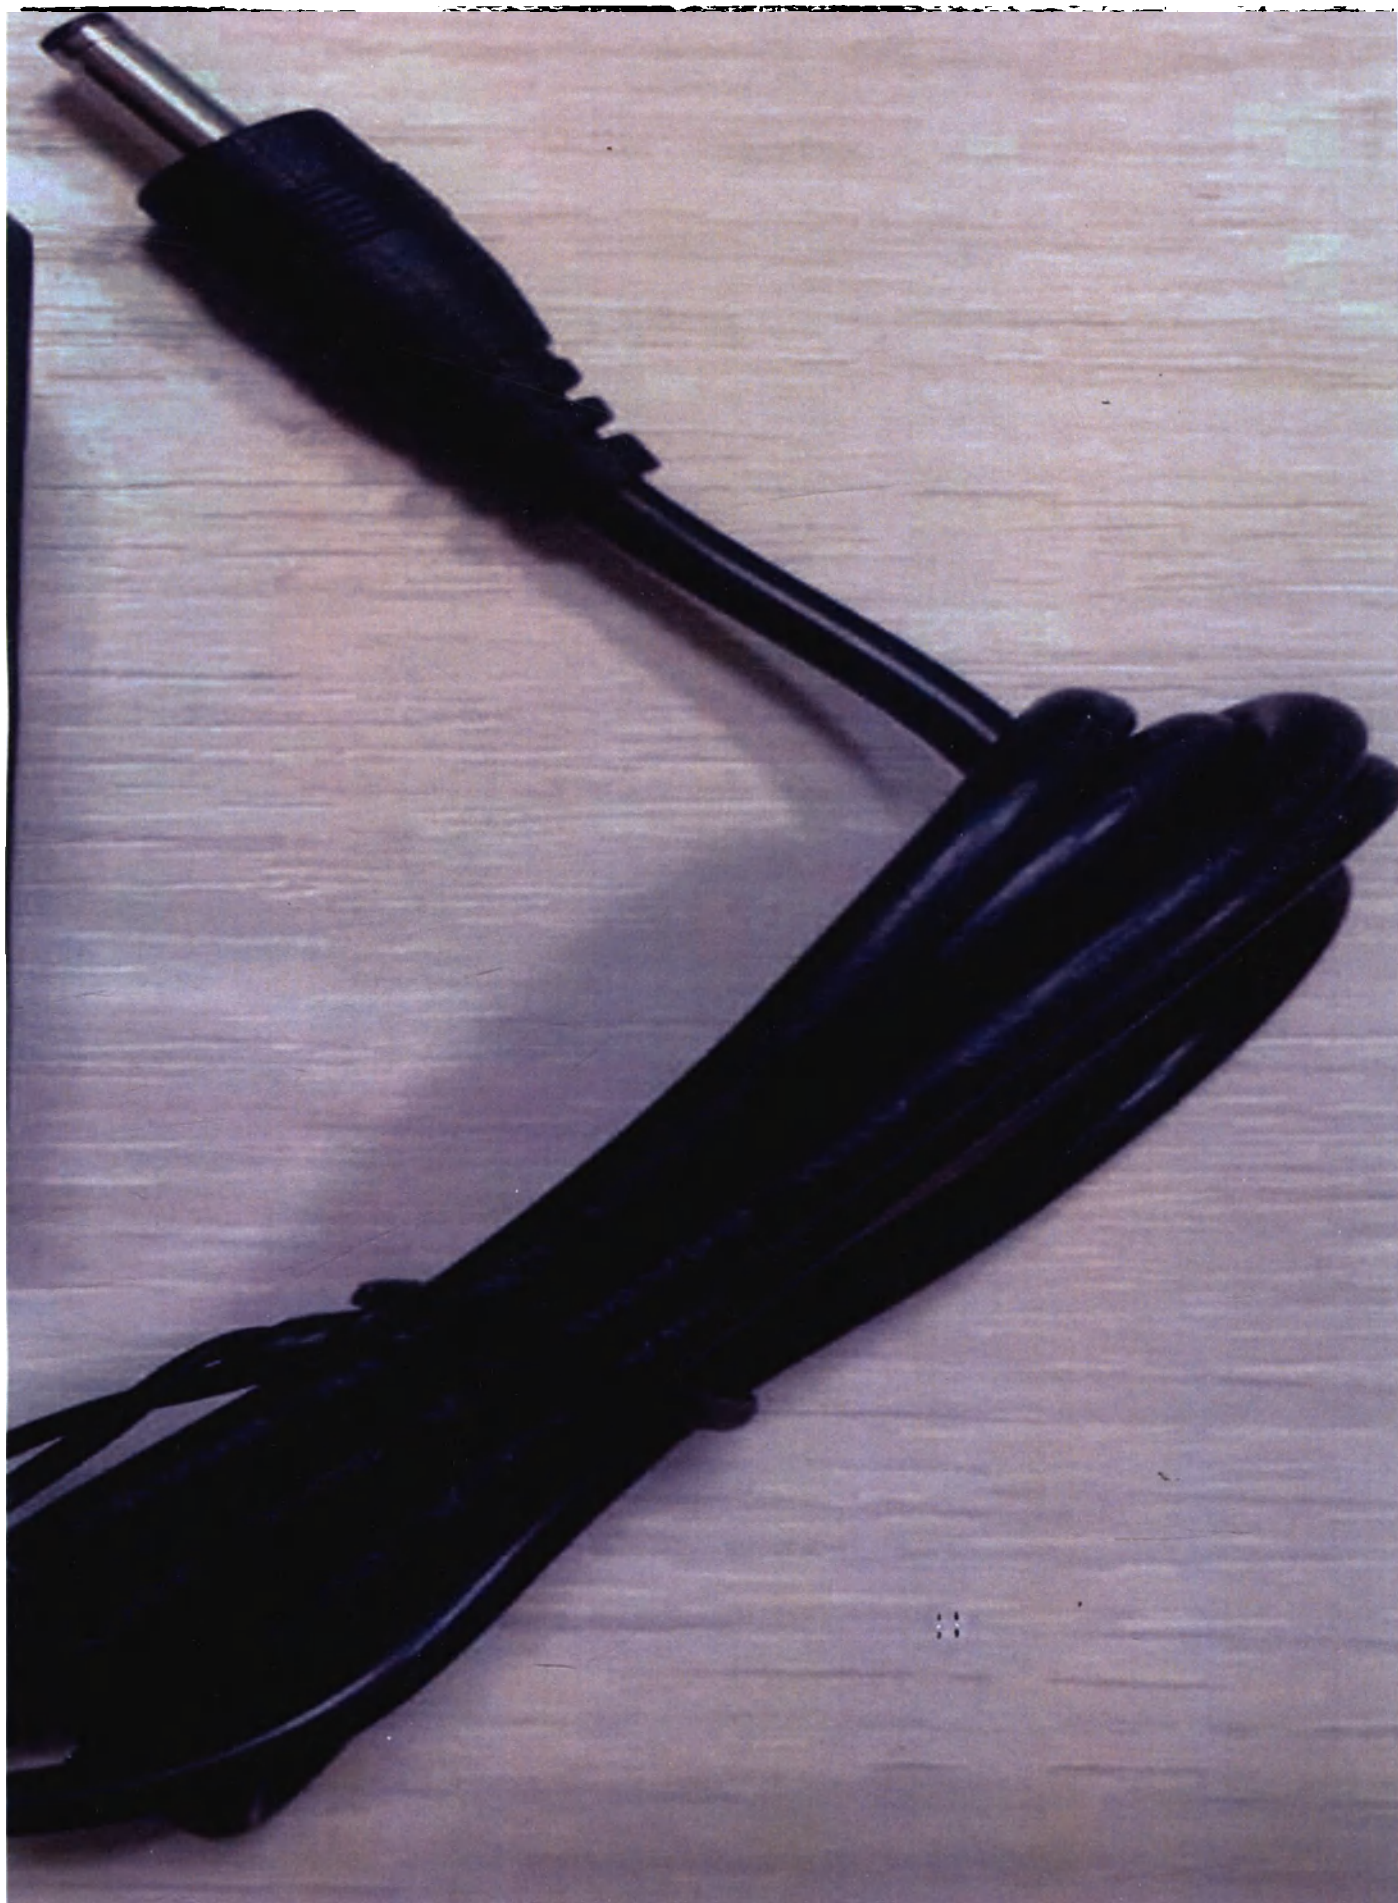


Рисунок 9. Фотографическое изображение *составляющего* медицинского изделия «Коагулометр оптический OCG-102»: Кабель сетевой

Всего пронумеровано и скреплено печатью

171

Генеральный директор ООО «ПРОФИЛАБТЕСТ»

А.И. Киреев

