

**Фотографические изображения
общего вида медицинского изделия:**

**Реагенты и расходные материалы для биохимического автоматического
анализатора "Витрос" (Vitros)**

**Внесение изменений в регистрационное удостоверение в медицинские
изделия:**


АЛТ - Alanine Aminotransferase (ALTV)

Железо - Iron (FE)

Щелочная фосфатаза - Alkaline Phosphatase (ALKP)

Референсный раствор электролитов: ERF 300, ERF 800

необходимыми для применения медицинского изделия по назначению



6844288

АЛТ (Аланинаминотрансфераза) - ALTV (Alanine Aminotransferase) реагенты

Область применения: для проведения биохимических исследований *in vitro* в диагностических лабораториях на анализаторах «Витрос» (Vitros)

Условия хранения: см. на упаковке

Срок годности: см. на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Производитель: «Орто-Клиникал Диагностика, Инк.», США

Предприятие изготовитель: «Орто-Клиникал Диагностика, Инк.», 100 Indigo Creek Drive, Rochester, New York 14626, USA (США)

Регистрационное удостоверение:

Уполномоченная организация на территории РФ: ООО «Орто-Клиникал Диагностика»

143026, Россия, Московская область, Одинцовский район, деревня Сколково, ул. Новая, дом 100, лит.А,А, Тел: +7 (499) 951-26-12

VITROS[®]
Chemistry


Products




ALTV
Slides





Ortho Clinical Diagnostics

REF 684 4288

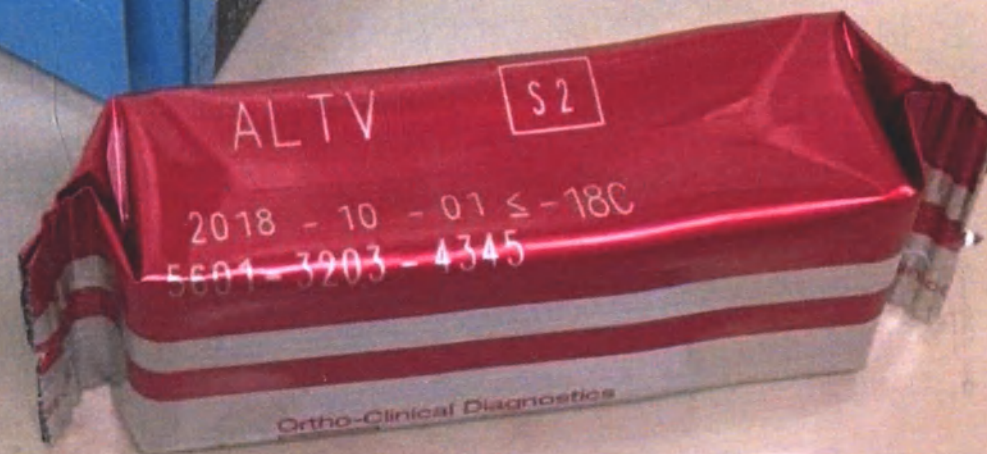

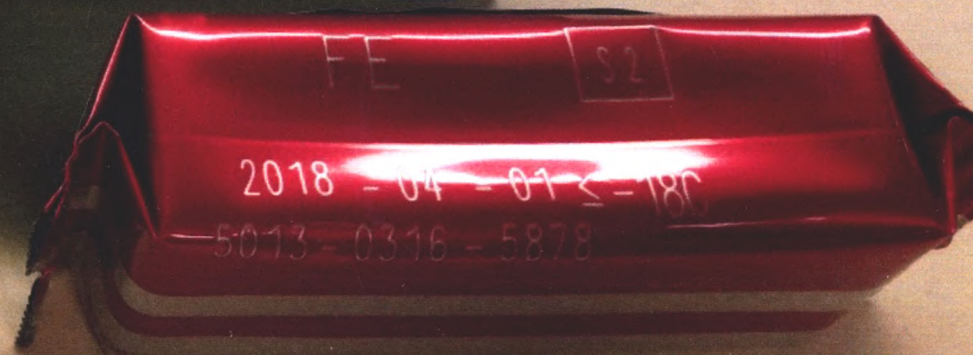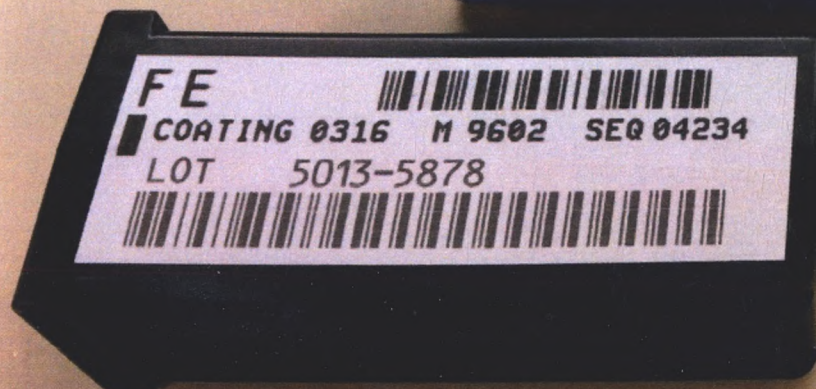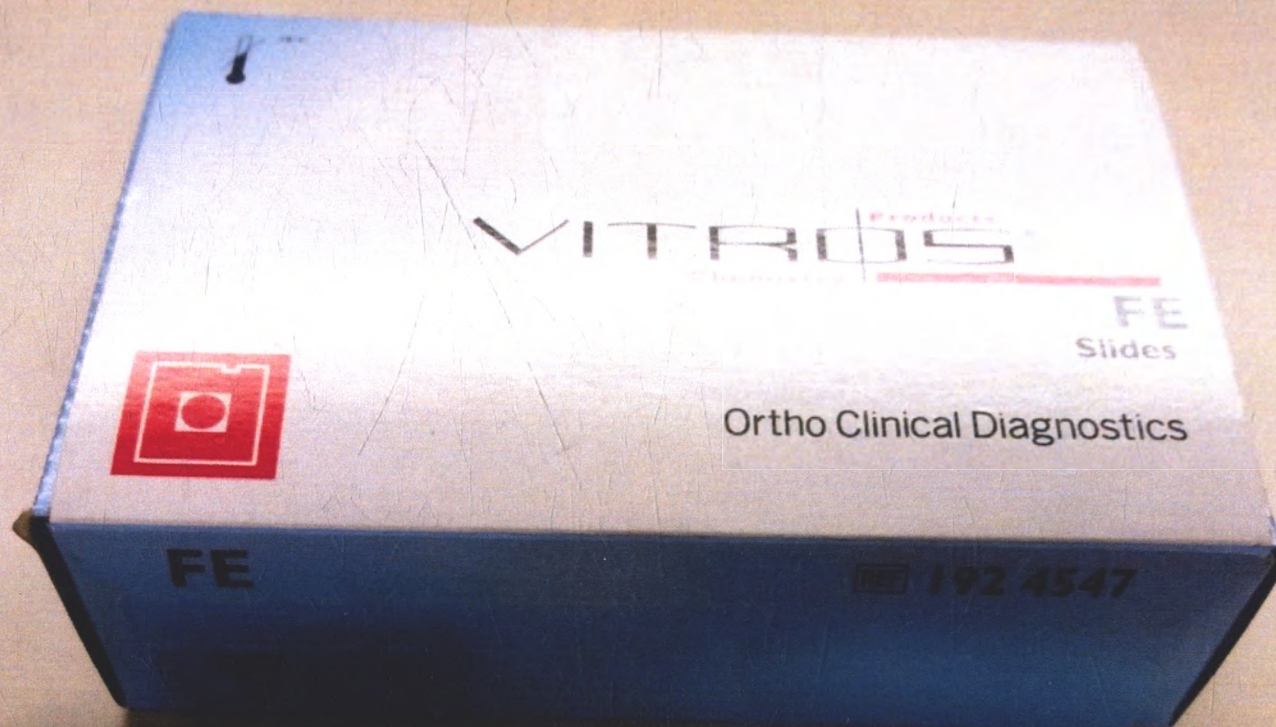

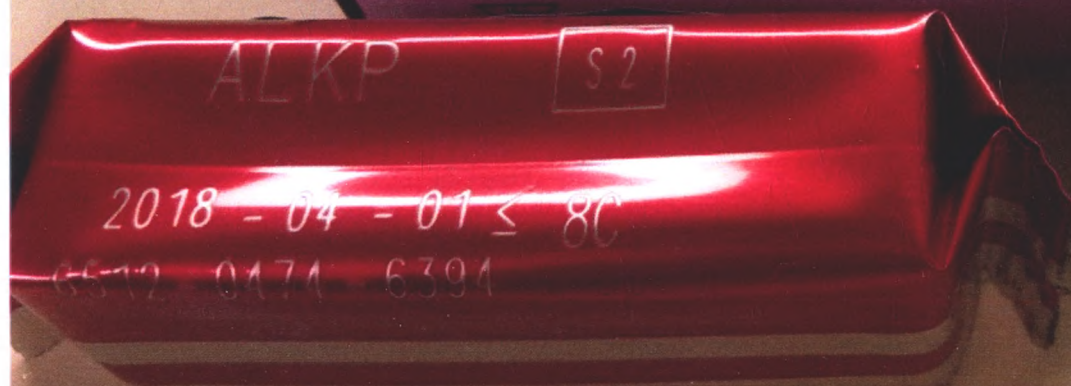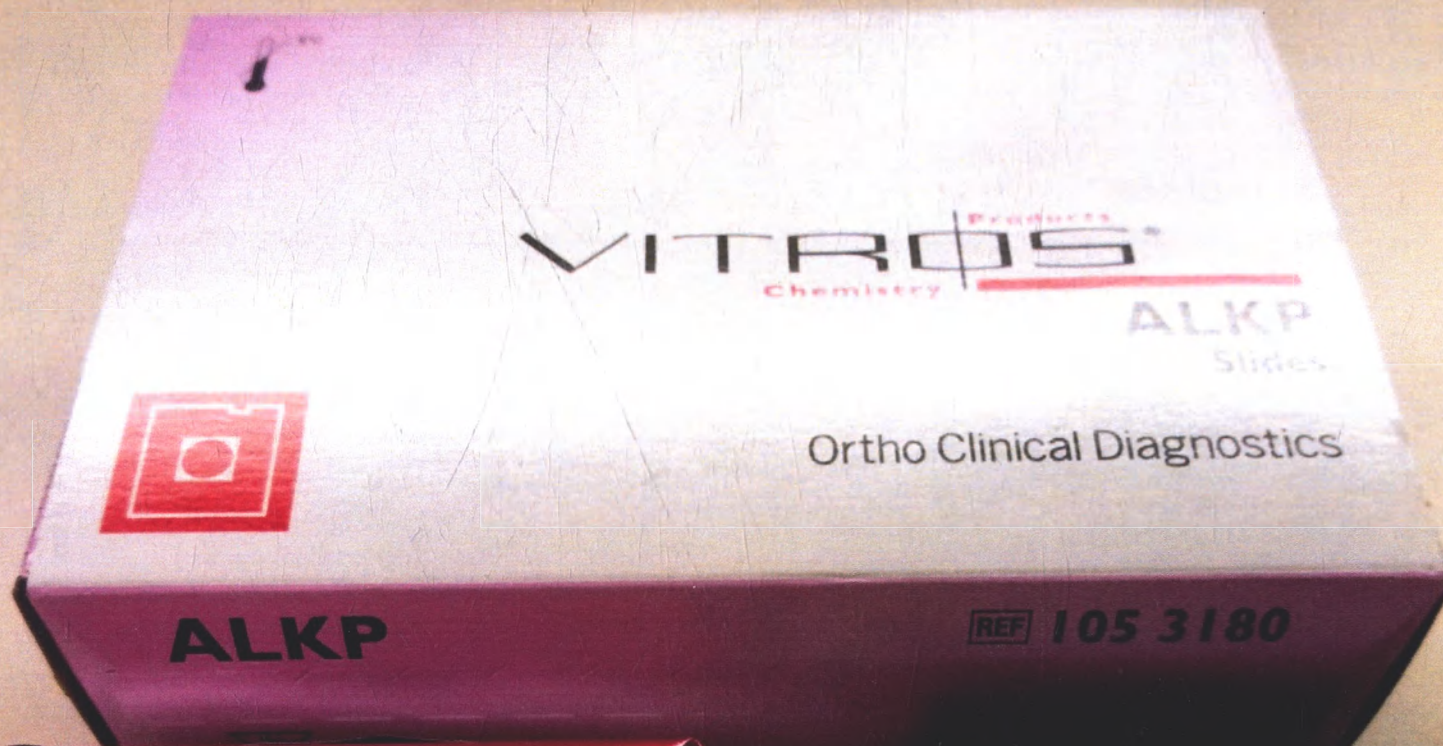

Electrolyte Reference Fluid (ERF) 300

Liquide de référence des électrolytes (ERF) 300

Elektrolytreferenzflüssigkeit (ERF) 300

Electrolyte Reference Fluid (ERF) 300

Líquido de referência dos eletrólitos (ERF) 300

Fluido di riferimento elettrolitico (ERF) 300

Elektrolytreferencevæske (ERF) 300

Elektrolytreferenslösning (ERF) 300


Elektrolytová referenční tekutina (ERF) 300

Elektrolit-referenciafolyadék (ERF) 300

Plłyn referencyjny (ERF) 300

Elektrolit Referans Sıvısı (ERF) 300

Na⁺, K⁺, Cl⁻

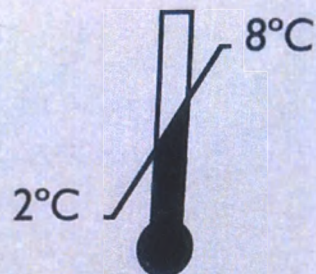

6844464

Референсный раствор электролитов ERF 300

Область применения: для проведения биохимических исследований *in vitro* в диагностических лабораториях на анализаторах «Витрос» (Vitros)

Условия хранения: см. на упаковке

Срок годности: см. на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Производитель: «Орто-Клиникал Диагностика, Инк.», США

Предприятие изготовитель: «Орто-Клиникал Диагностика, Инк.», 100 Indigo Creek Drive, Rochester, New York 14626, USA (США)

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2007/01001 от 02.10.2017

Уполномоченная организация на территории РФ: ООО «Орто-Клиникал Диагностика»

143026, Россия, Московская область, Одинцовский район, деревня Сколково, ул. Новая, дом 100, лит.А,А,
Тел: +7 (499) 951-26-12

LOT



L6399 2020-01-08



(01)10758750031665

(17)200108

(10)L6399



2018-01-08



B

REF

684 4464

30x6 mL



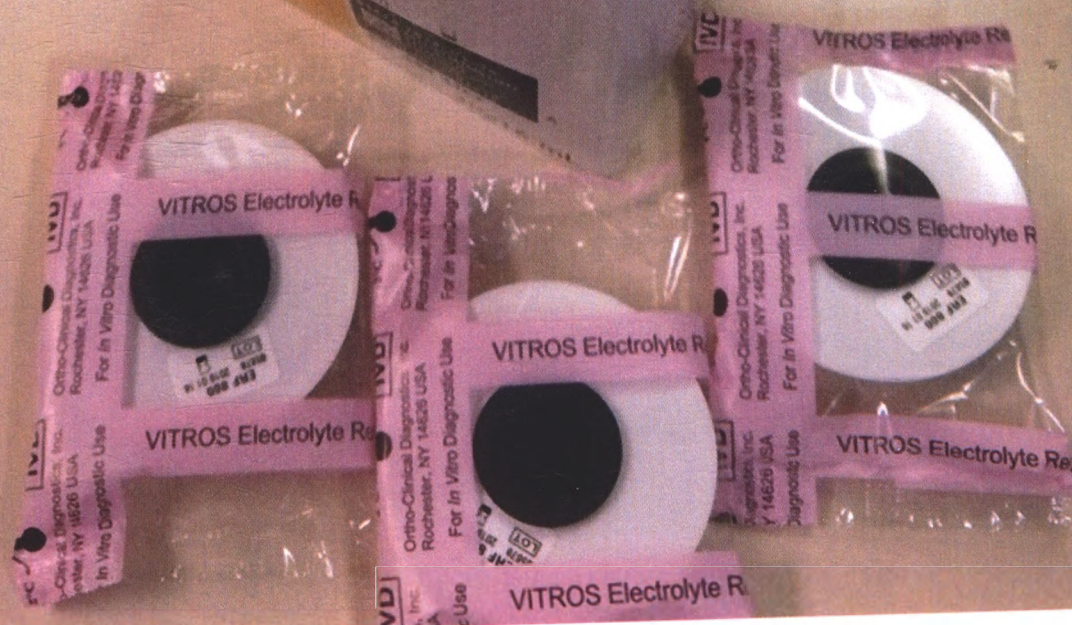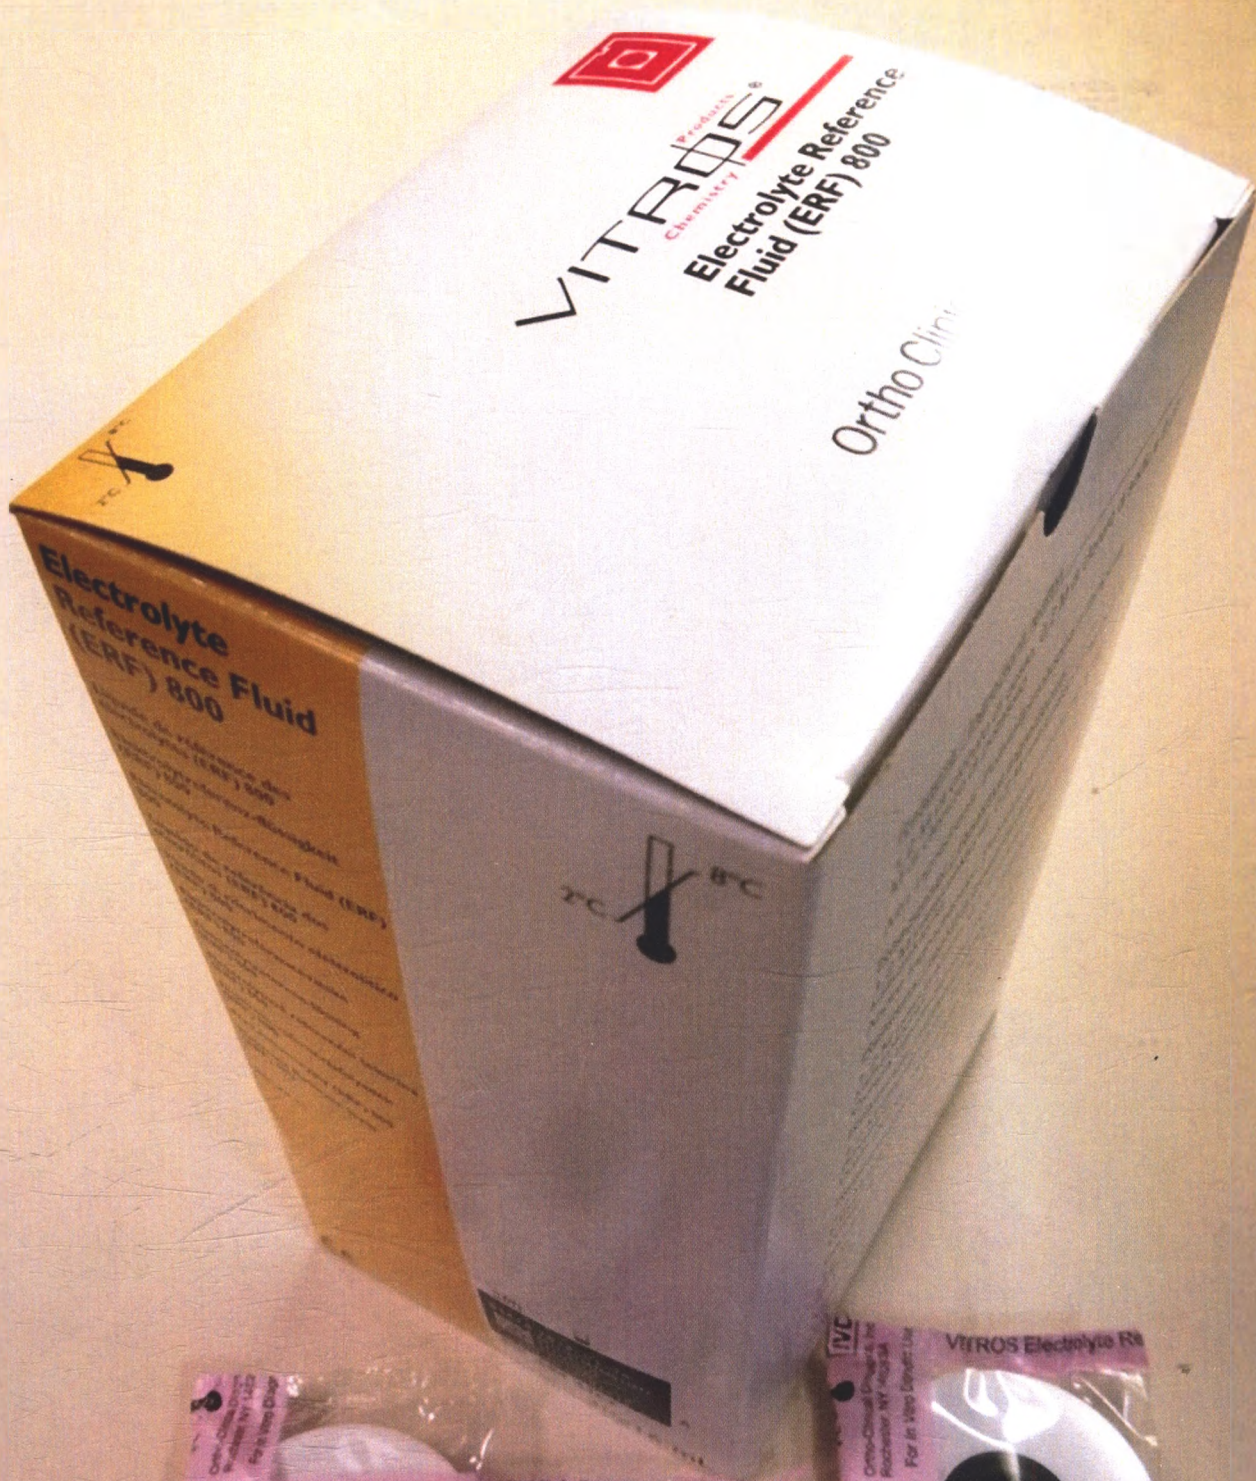

Electrolyte Reference Fluid (ERF) 800

Liquide de référence des
électrolytes (ERF) 800

Elektrolytreferenz-flüssigkeit
(ERF) 800

Electrolyte Reference Fluid (ERF)
800

Líquido de referência dos
eletrólitos (ERF) 800

Fluido di riferimento elettrolitico
(ERF) 800

Elektrolytreferencevæske
(ERF) 800

Elektrolytferens-lösning
(ERF) 800


Elektrolytová referenční tekutina
(ERF) 800

Elektrolit-referenciafolyadék
(ERF) 800

Płyn referencyjny (ERF) 800

Elektrolit Referans Sıvısı
(ERF) 800

Na⁺, K⁺, Cl⁻

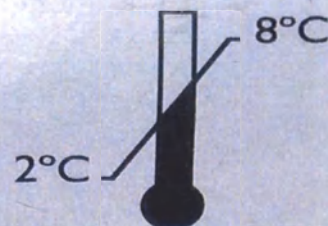

6844463

Референсный раствор электролитов ERF 800

Область применения: для проведения биохимических исследований *in vitro* в диагностических лабораториях на анализаторах «Витрос» (Vitros)

Условия хранения: см. на упаковке

Срок годности: см. на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

Производитель: «Орто-Клиникал Диагностика, Инк.», США

Предприятие изготовитель: «Орто-Клиникал Диагностика, Инк.», 100 Indigo Creek Drive, Rochester, New York 14626, USA (США)


Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2007/01001 от 02.10.2017

Уполномоченная организация на территории РФ:

ООО «Орто-Клиникал Диагностика»
143026, Россия, Московская область, Одинцовский район, деревня Сколково, ул. Новая, дом 100, лит.А,А,

Тел: +7 (499) 951-26-12

Reference Fluid 800 BX/30 6844463



2 8 9 4 5 2 1 1 4 6 4 1 9

LOT



Q6686 2020-05-04



(01) 10758750031672
(17) 200504
(10) Q6686



2018-05-04

B

REF 684 4463

30x16 mL

№ 04 2020 г.
Генеральный директор
ООО «Орто-Клиникал Диагностикс»

Сергеенко В.К.

