

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Анализатор автоматический иммунохемилюми-
несцентный MAGLUMI® 2000 Plus с принадлеж-
ностями***

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КЛС»

Смирнов Э.А.

2023 г.




Основной блок анализатора



Системный блок компьютера с программным обеспечением анализатора




Монитор



Клавиатура и Мышка



Коврик для мыши



Монтажное место для монитора



Мешок для отходов




Контейнер для отходов реакционных модулей



Канистра для отходов жидкости




Канистра для системной жидкости




Кабель питания




Кабель RS-232 (Кабель для соединения компьютера с анализатором)



Кабель RS-232 (Кабель для соединения ЛИС)

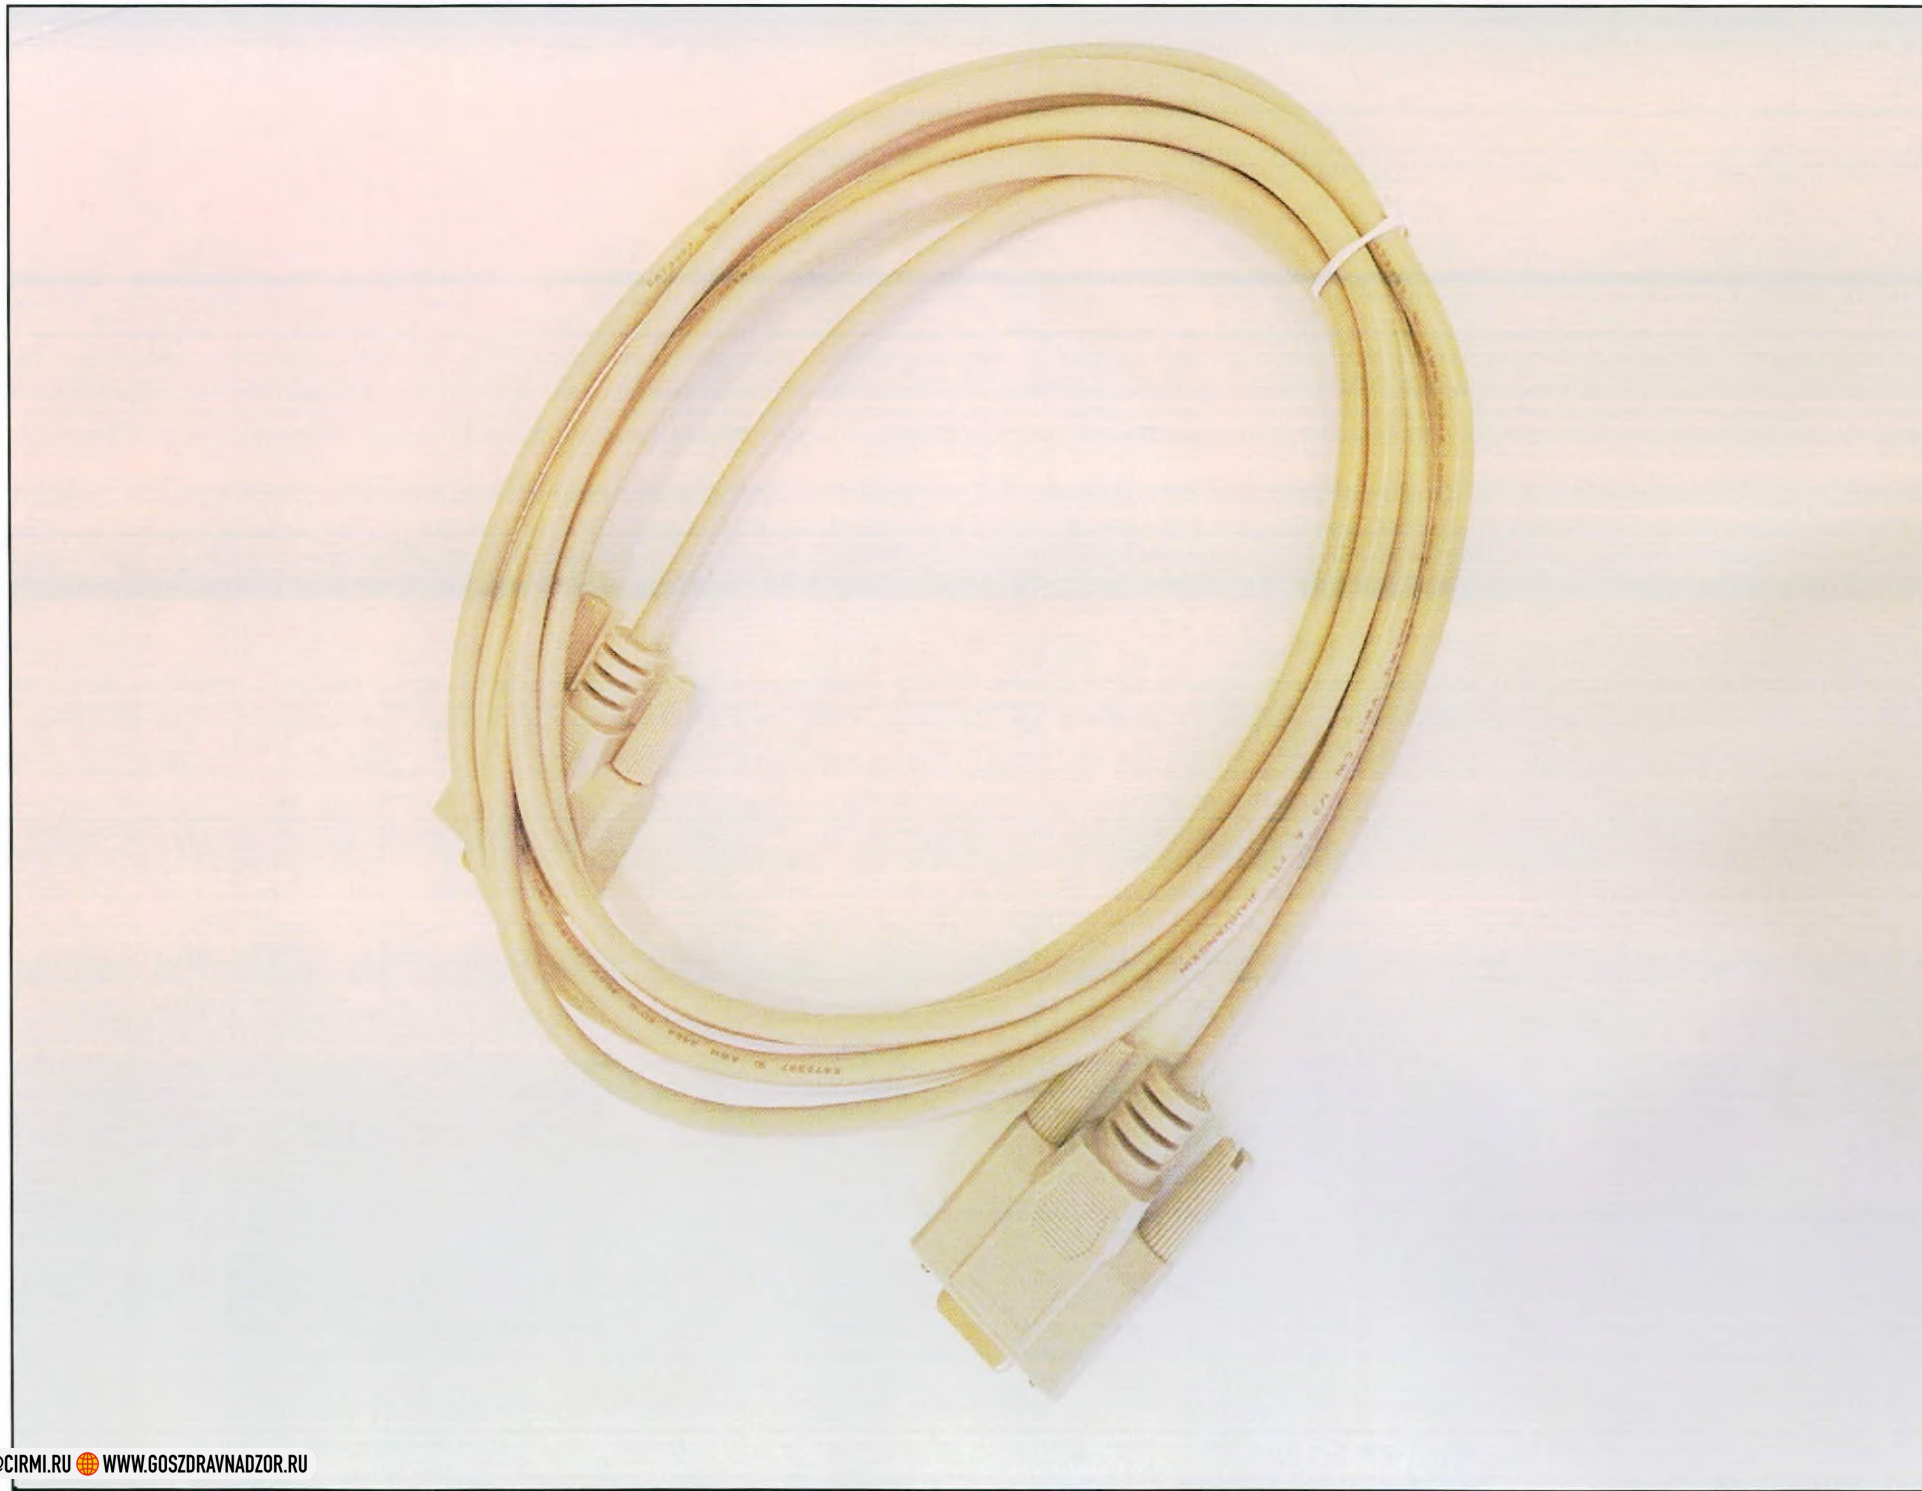

Кабель RS-232 (Кабель для обновления прошивки)





040200002302

Руководство по эксплуатации

Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный
MAGLUMI® в вариантах исполнения с принадлежностями

Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд

**QUALITY CONTROL CERTIFICATE**

Product name: Fully-Auto Chemiluminescence Immunoassay Analyzer

Type : MAGLUMI 2000 Plus

Serial No. : 
0101010009022200089

Manufacturer : Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd

This is to certify the above analyzer meets the required standard which is product registration standard and passes the quality control tests.

Auditors: Chen Dawei


Chen Dawei

QC Dept. Manager


Auditing Date: 13.10.2022

Принадлежности


Лоток для штативов



Игла-пипетка




Зубчатая рейка для оси Z



080403000201



080403000301



080403000401



Предохранитель 15,0А

080403000501



Перемычка


100601000702




Ключи от крышки анализатора




Адаптер вглы-пипетки



Пластиковые крышки для зубчатой рейки для оси Z



Инструмент позиционирования (М2000Р-15-01)

Инструмент для определения диаметра пробирки



Набор шестигранных ключей



Трубка для соединения канистр системной жидкости





Инструмент для распаковки



Лоток для набора реагентов



Пылезащитный чехол





Пробирка для координации иглы-пипетки



Всего прошнуровано и
скреплено 39 лист «об»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СМИРНОВ



Фотографические изображения
медицинского изделия

***Анализатор автоматический иммунохемилюми-
несцентный MAGLUMI[®] 800
с принадлежностями***

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор


ООО «КЛС»

Смирнов Э.А.

2023 г.



Основной блок анализатора



Системный блок компьютера с программным обеспечением анализатора



Монитор



Клавиатура и Мышка



Коврик для мыши




Мешок для отходов



Контейнер для отходов реакционных модулей




Канистра для системной жидкости




Канистра для отходов жидкости



Датчик уровня жидкости в канистре для системной жидкости




Датчик уровня жидкости в канистре для отходов жидкости




Кабель питания




Кабель RS-232 (Кабель для обновления прошивки)



Кабель RS-232 (Кабель для соединения ЛИС)



Кабель RS-232 (Кабель для соединения компьютера с анализатором)

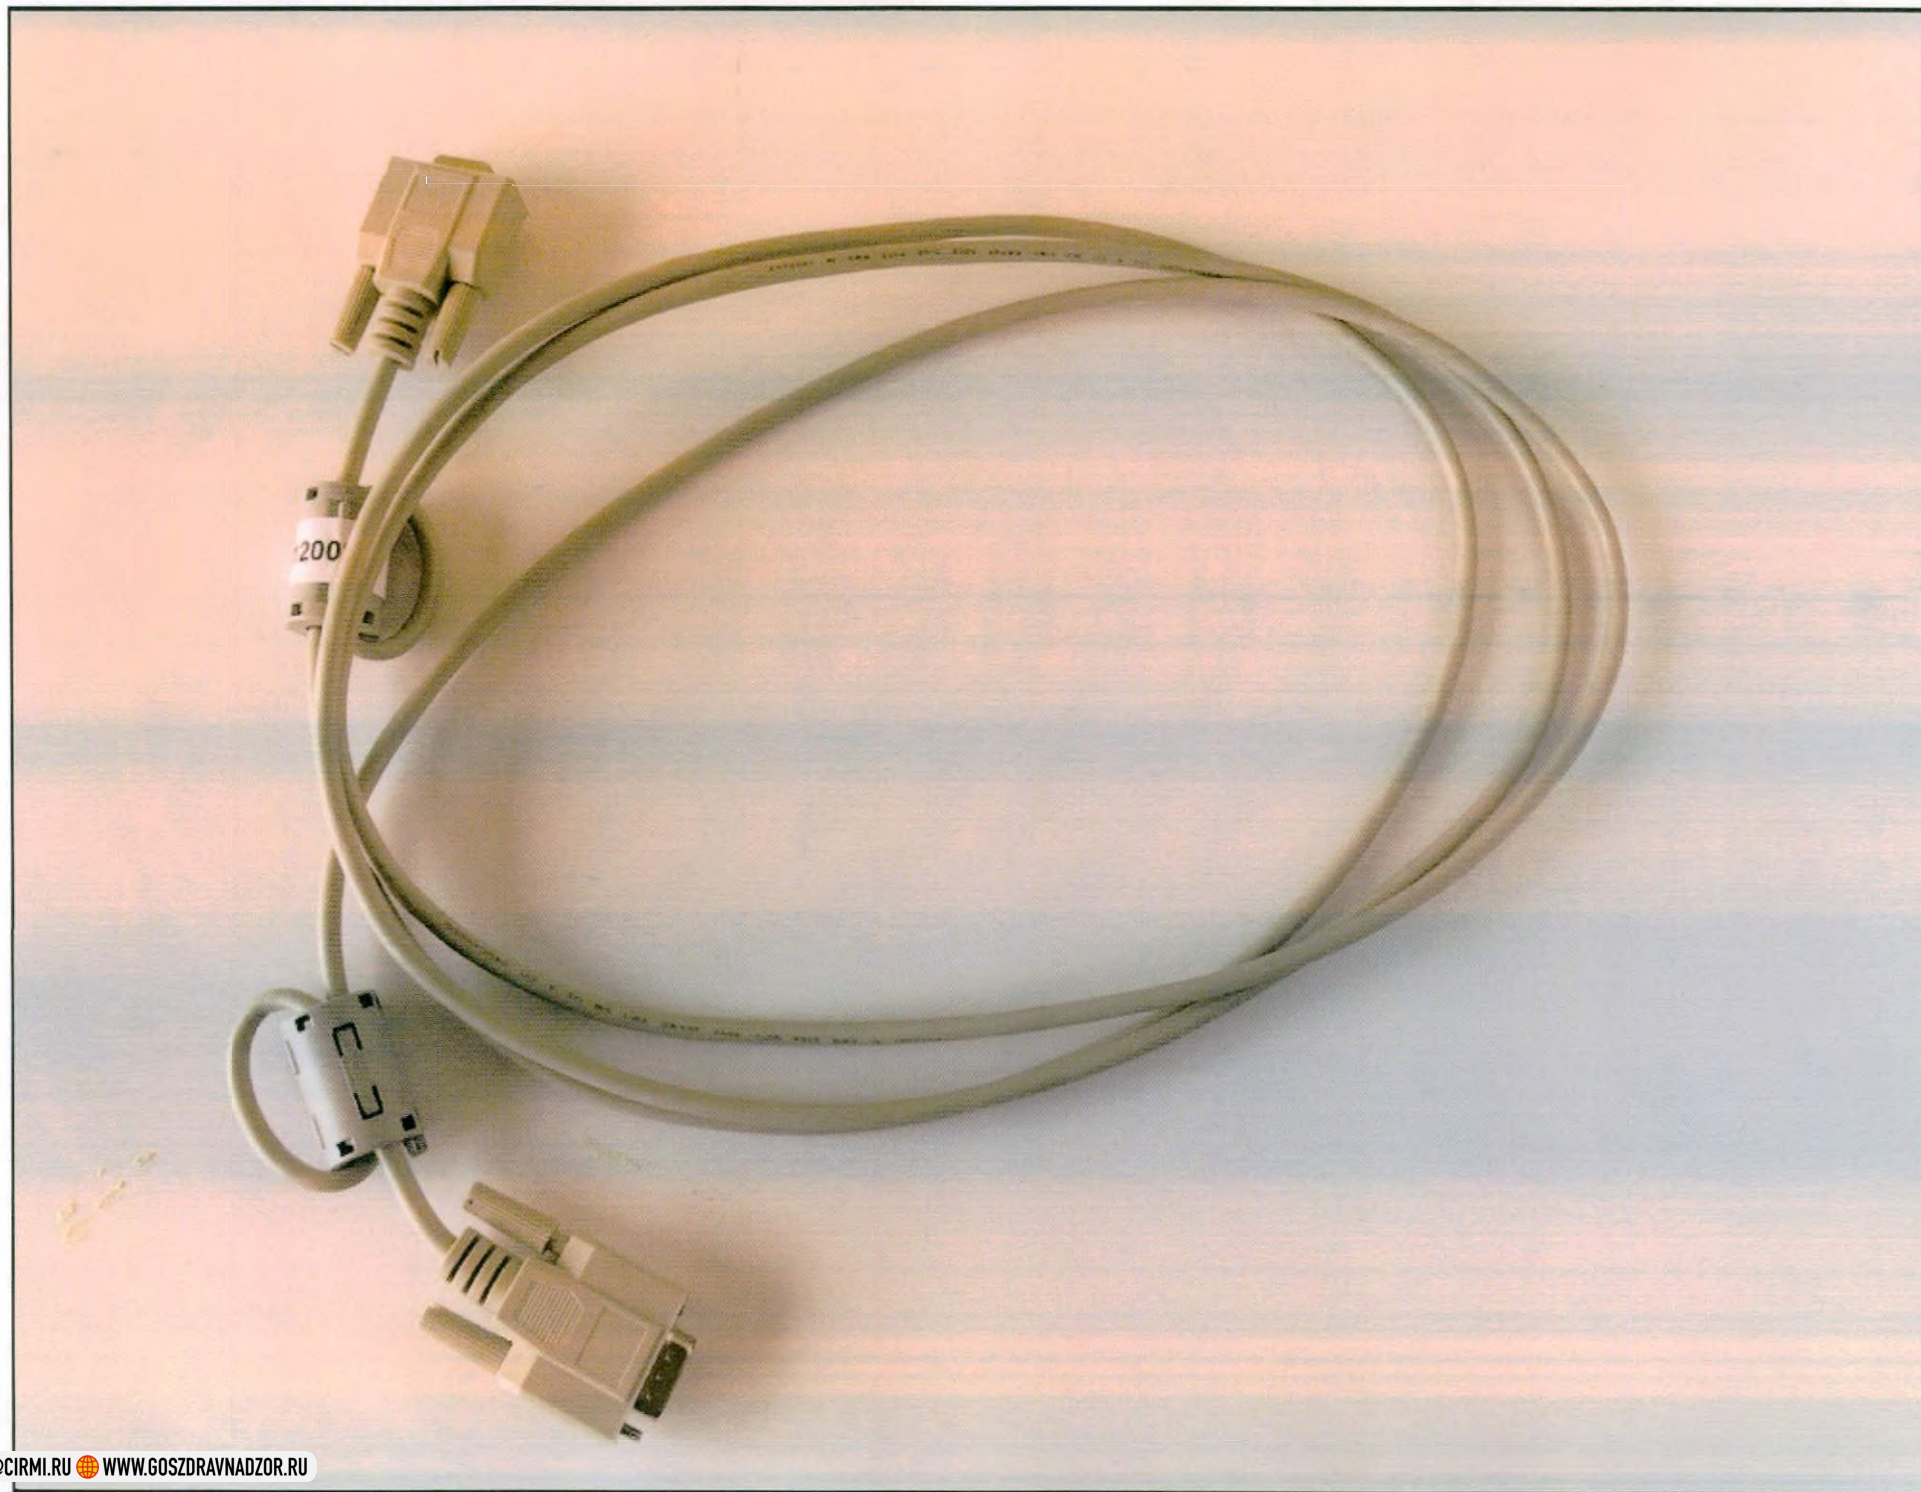




040200002302

Руководство по эксплуатации

Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный
MAGLUMI®, в вариантах исполнения с принадлежностями

Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд



QUALITY CONTROL CERTIFICATE

Product name: Fully-Auto Chemiluminescence Immunoassay Analyzer


Type : MAGLUMI 800

Serial No. : 
0101010012022201896

Manufacturer : Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd

This is to certify the above analyzer meets the required standard which is product registration standard and passes the quality control tests.

Auditors: Chen Dawei



QC Dept. Manager

Auditing Date: 13.10.2022

Принадлежности

Лоток для набора реагентов


Инструмент для определения диаметра пробирки



Ключи от крышки анализатора




Лоток для штативов




Пробирка для координации иглы-пипетки



Крестовая отвертка



Трубка для соединения канистр системной жидкости





080403000201




080403000301



080403000401



080403000501



Набор шестигранных ключей





Перемычка

100601000702


СЕРИЯ

Набор инструмента для очистки иглы






Лоток для штативов




Инструмент для распаковки



Пылезащитный чехол





ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО 39 ЛИСТ«ОВ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СМИРНОВ Э.А.



Фотографические изображения
медицинского изделия

***Анализатор автоматический
иммунохемилюминесцентный MAGLUMI X3
с принадлежностями***

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор




Смирнов Э.А.

2023 г.

Основной блок анализатора





Монитор




Клавиатура и Мышка



Ключи от крышки анализатора



Мешок для отходов реакционных чашечек



Канистра для системной жидкости



Канистра для отходов концентрированной жидкости



Канистра для отходов неконцентрированной жидкости



Датчик уровня жидкости в канистре системной жидкости



Датчик уровня жидкости в канистре отходов концентрированной жидкости




Датчик уровня жидкости в канистре отходов неконцентрированной жидкости




Сетевой кабель




Кабель RS-232 (Кабель для соединения компьютера с анализатором)




Кабель RS-232 (Кабель для соединения ЛИС)



Кабель RS-232 (Кабель для обновления прошивки)



Трубка для сбора кабелей



Кабель питания



'072806000301

QUALITY CONTROL CERTIFICATE

Product name: Fully-Auto Chemiluminescence Immunoassay Analyzer**Type :** MAGLUMI X3**Serial No. :** 
0101010034012200627**Manufacturer :** Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd

This is to certify the above analyzer meets the required standard which is product registration standard and passes the quality control tests.

Auditors: Chen Dawei*Chen Dawei*

QC Dept. Manager

Auditing Date: 8.12.2022

Snibe

040200015901

Автоматический хемилюминесцентный
иммунологический анализатор

MAGLUMI®
ХЭ

Руководство по эксплуатации

Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd.

Принадлежности


Предохранитель 10,0 А



Заглушка




Инструмент для очистки иглы-пипетки



Инструмент для определения диаметра пробирки



Трубка для соединения канистр системной жидкости



Пробирка для координации иглы-пипетки






Инструмент позиционирования (X3-G-09-02)




Инструмент позиционирования (X3-G-02-16)




Инструмент позиционирования (X3-G-00-05)




Инструмент позиционирования (X3-G-00-05A)



Инструмент позиционирования (M6000-G-06-09)

Инструмент позиционирования (X3-G-04-01)



Воронка




Крестовая отвертка



Разводной гаечный ключ



Ящик для реакционных чашечек



Ящик для хранения реагентов



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СМИРНОВ Э.А.

ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО 1
СКРЕПЛЕНО 43 ЛИСТОВ



Фотографические изображения
медицинского изделия

***Анализатор автоматический
иммунохемилюминесцентный MAGLUMI X8
с принадлежностями***

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



Смирнов Э.А.


2023 г.

Основной блок анализатора



Блок для образцов






Монитор




Клавиатура и Мышка



Настенное крепление для монитора




Кабель питания для панели управления




Кабель питания




Кабель RS-232 (Кабель для обновления прошивки)



Кабель RS-232 (Кабель для соединения ЛИС)




Кабель RS-232 (Кабель для соединения компьютера с анализатором)




Сетевой кабель основного блока



Сетевой кабель области образцов



Канистра для системной жидкости



Канистра для отходов неконцентрированной жидкости



Канистра для отходов концентрированной жидкости



Датчик уровня жидкости в канистре неконцентрированной жидкости



Датчик уровня жидкости в канистре концентрированной жидкости



Ключи от крышки анализатора



Мешок для отходов реакционных чашечек





072806000301

QUALITY CONTROL CERTIFICATE

Product name: Fully-Auto Chemiluminescence Immunoassay Analyzer

Type : MAGLUMI X8

Serial No. : 
0101010089012300001

Manufacturer : Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd

This is to certify the above analyzer meets the required standard which is product registration standard and passes the quality control tests.

Auditors: Chen Dawei

Chen Dawei

QC Dept. Manager

Auditing Date: 8.1.2023



040200013601

Автоматический хемилюминесцентный
иммунологический анализатор

MAGLUMI®
ХВ

Руководство по эксплуатации

Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd.

Принадлежности

Заглушка


022202000201



Инструмент для очистки иглы-пневтики



Винты с шестигранной головкой



Стандартная пружинная шайба




Инструмент для определения диаметра пробирки




Плоская шайба класса А



Инструмент позиционирования (M6000-G-04-04)




Инструмент позиционирования (М6000-G-00-04)




Инструмент позиционирования (М6000-G-00-03)






Инструмент позиционирования (М6000-G-00-01)



Инструмент позиционирования (М6000-G-15-01)




110200002001





Инструмент позиционирования (М6000-G-03-01)




110300000401

03-G-0

110300001201



Инструмент позиционирования (М6000-G-01-02)


Инструмент позиционирования (М6000-G-01-03)



110300004301



110300004501




110300004601




110300021401

Инструмент позиционирования (М6000-G-15-03)



Инструмент позиционирования (М6000-G-00-15)



Инструмент позиционирования (Х6-Г-02-02)

Набор шестигранных ключей




Прокладка для мотора

A photograph showing four circular gaskets, likely made of brass or a similar metal, arranged in a 2x2 grid inside a clear plastic bag. A white rectangular label is placed over the center of the gaskets, displaying the part number 020100119401 in bold black text. The gaskets have a slightly raised, flange-like edge and a smooth, polished surface.

020100119401


Крестовая отвертка




Воронка



Внутренний шестигранный ключ №1



Внутренний шестигранный ключ №2



070401010601




Пробирка для координации иголы-пипетки




Инструмент для распаковки



Ящик для хранения реагентов






Силиконовая трубка (0,8м)




Прозрачная армированная трубка (5м)





Ящик для реакционных чашечек



Комплект наборов штативов для образцов



Разводной гаечный ключ






Соединитель СРС




Трубка перистальтического насоса

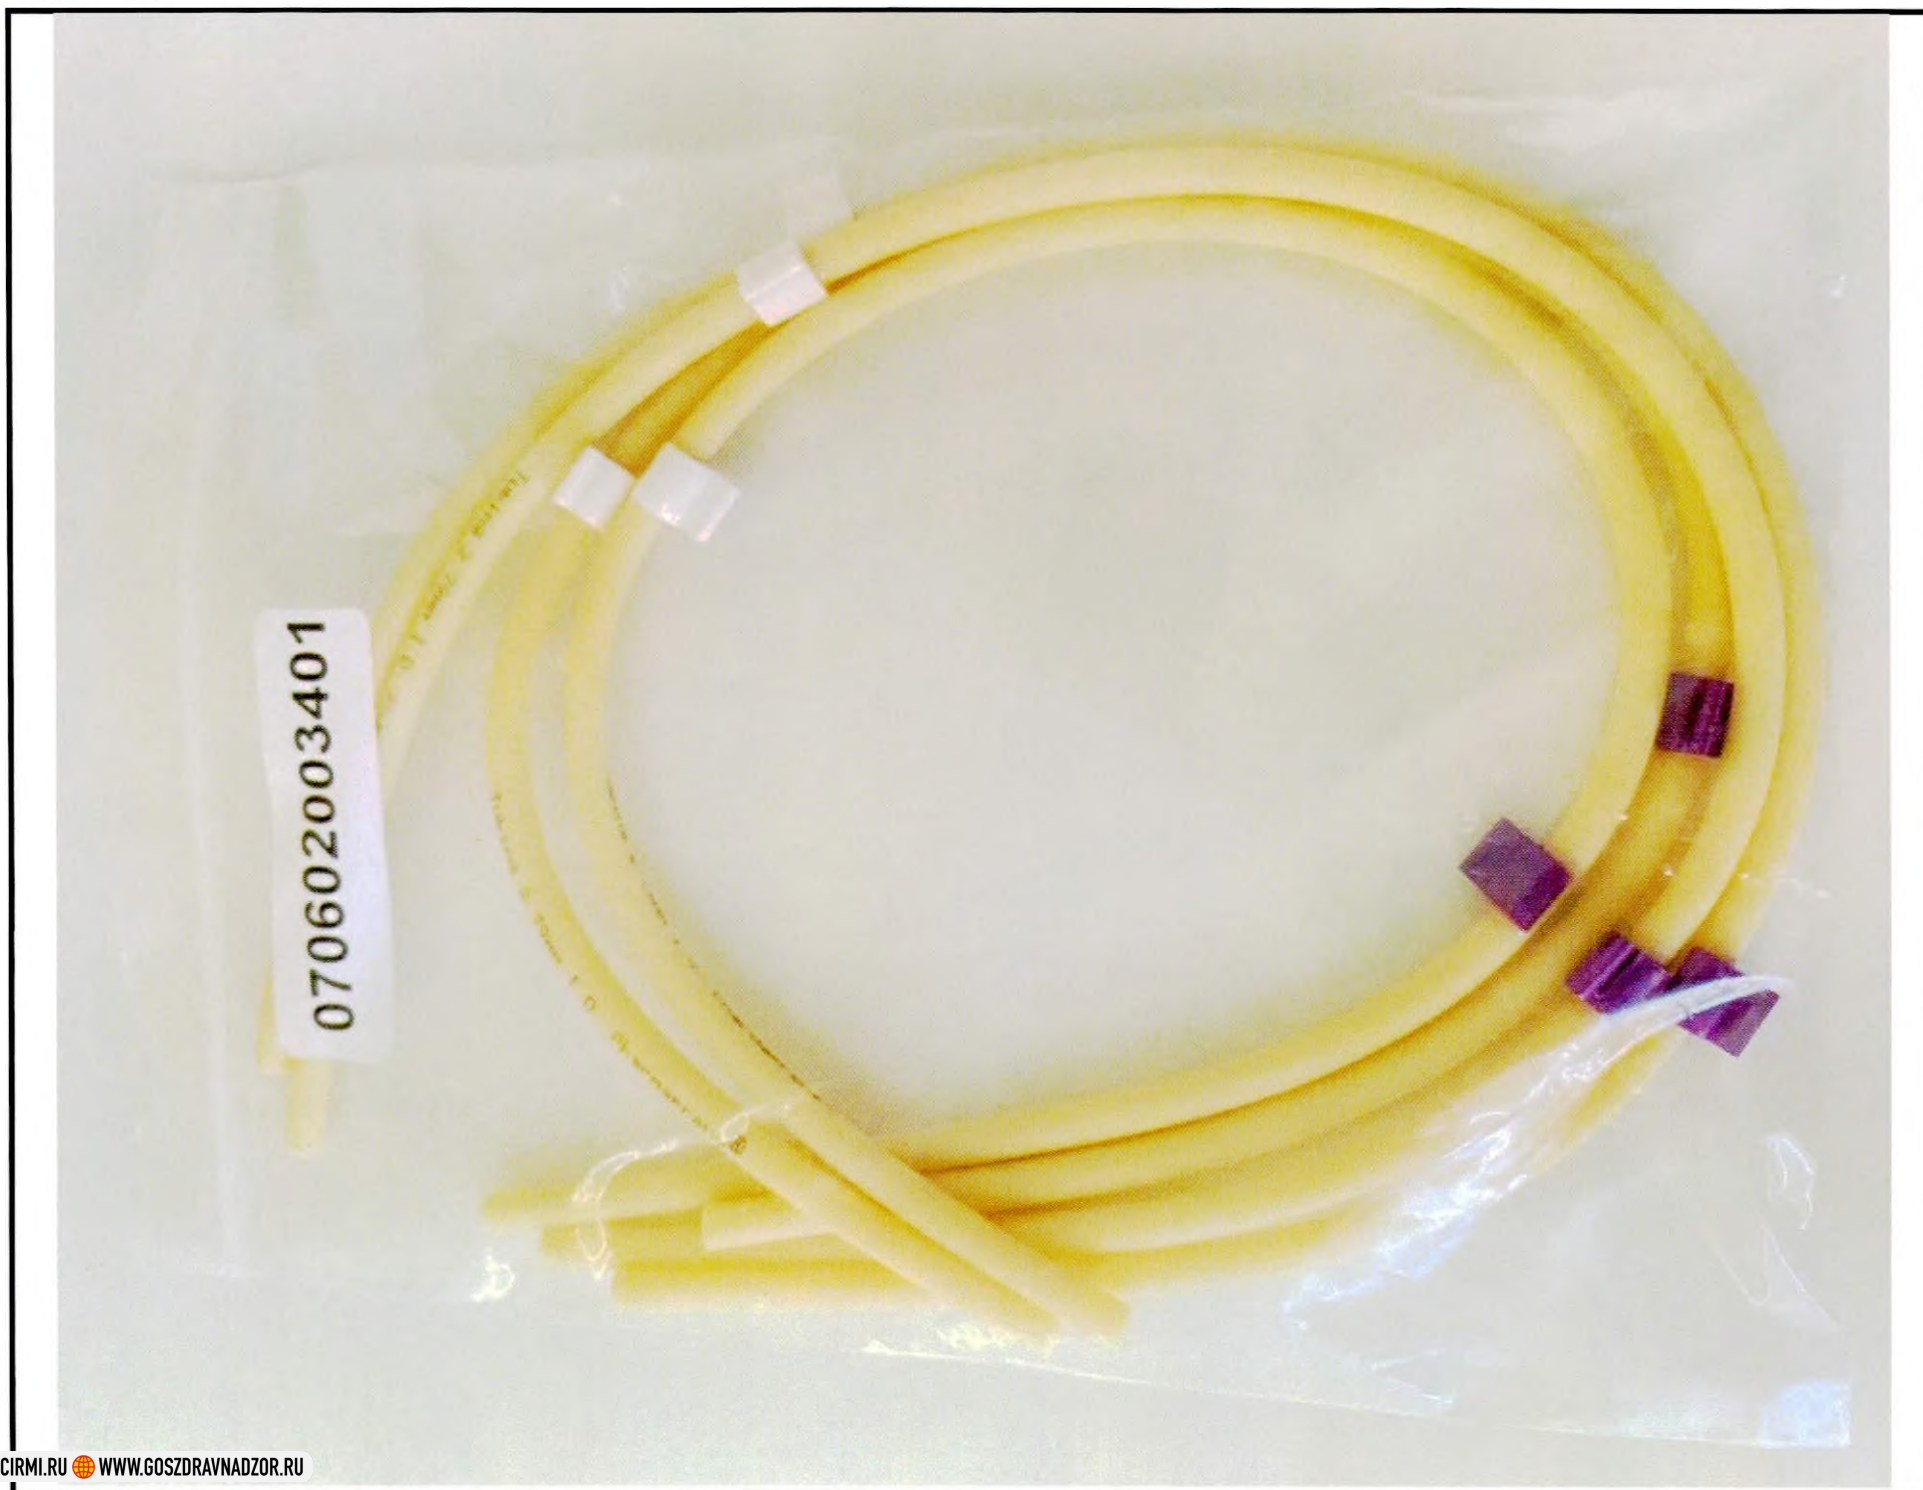

Запасная трубка перистальтического насоса




Дроссельная пробка



Синхронный шкив





070814000301

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СМИРНОВ Э.А.

Всего прошнуровано и
скреплено 75 листов

